

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Дрегер»,

Харитонов А.А.



2017 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Инкубатор для новорожденных, трансформируемый в открытую реанимационную систему
Babyleo TN500 с принадлежностями

ООО «Дрегер»

Юридический адрес:
Электроводская ул., д.33,
стр. 4.
Москва, Россия, 107076

Фактический адрес:

Преображенская площадь, д.8.
Бизнес Центр ПРЕО8, блок «Б»,
12 этаж
Москва, Россия, 107061

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23558 Lübeck, Germany
Почтовый адрес:
23542 Lübeck, Germany
Tel +49 451 882-0
Fax +49 451 882-2080

Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
23560 Lübeck, Germany

Tel +49 451 882-0
Fax +49 451 882-2080

Тел.: +7 495 775-15-20/21
ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ
Факс: +7 495 775-15-21
www.draeger.ru

Сервисный центр:
Электроводская ул., д.33, стр.4
Москва, Россия, 107076

info@draeger.com
www.draeger.com

info@draeger.com



Базовый блок Babyleo TN500



Управляющий дисплей



Поднимающийся колпак инкубатора



Кабель питания

Dräger

**Инкубатор для новорожденных,
трансформируемый в открытую реанимационную
систему Babyleo TN500 с принадлежностями**

Руководство по эксплуатации



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Для надлежащего применения
этого медицинского аппарата
изучите и соблюдайте данное
руководство по эксплуатации.

Программное обеспечение 1.0п

Руководство по эксплуатации



Certificate of Software License

Software option

Auto termo package 2M60105

Part Number AT 60105

Serial Number 6003560105

Опция AutoThermo



Certificate of Software License

Software option

Developmental care package 2M60905

Part Number AT 60905

Serial Number 6003560905

Опция "Развивающий уход"



Certificate of Software License


Software option

Servo oxygen package OPC6628


Part Number AT 6628

Serial Number 600356628


Опция "Сервоконтроль концентрации кислорода"

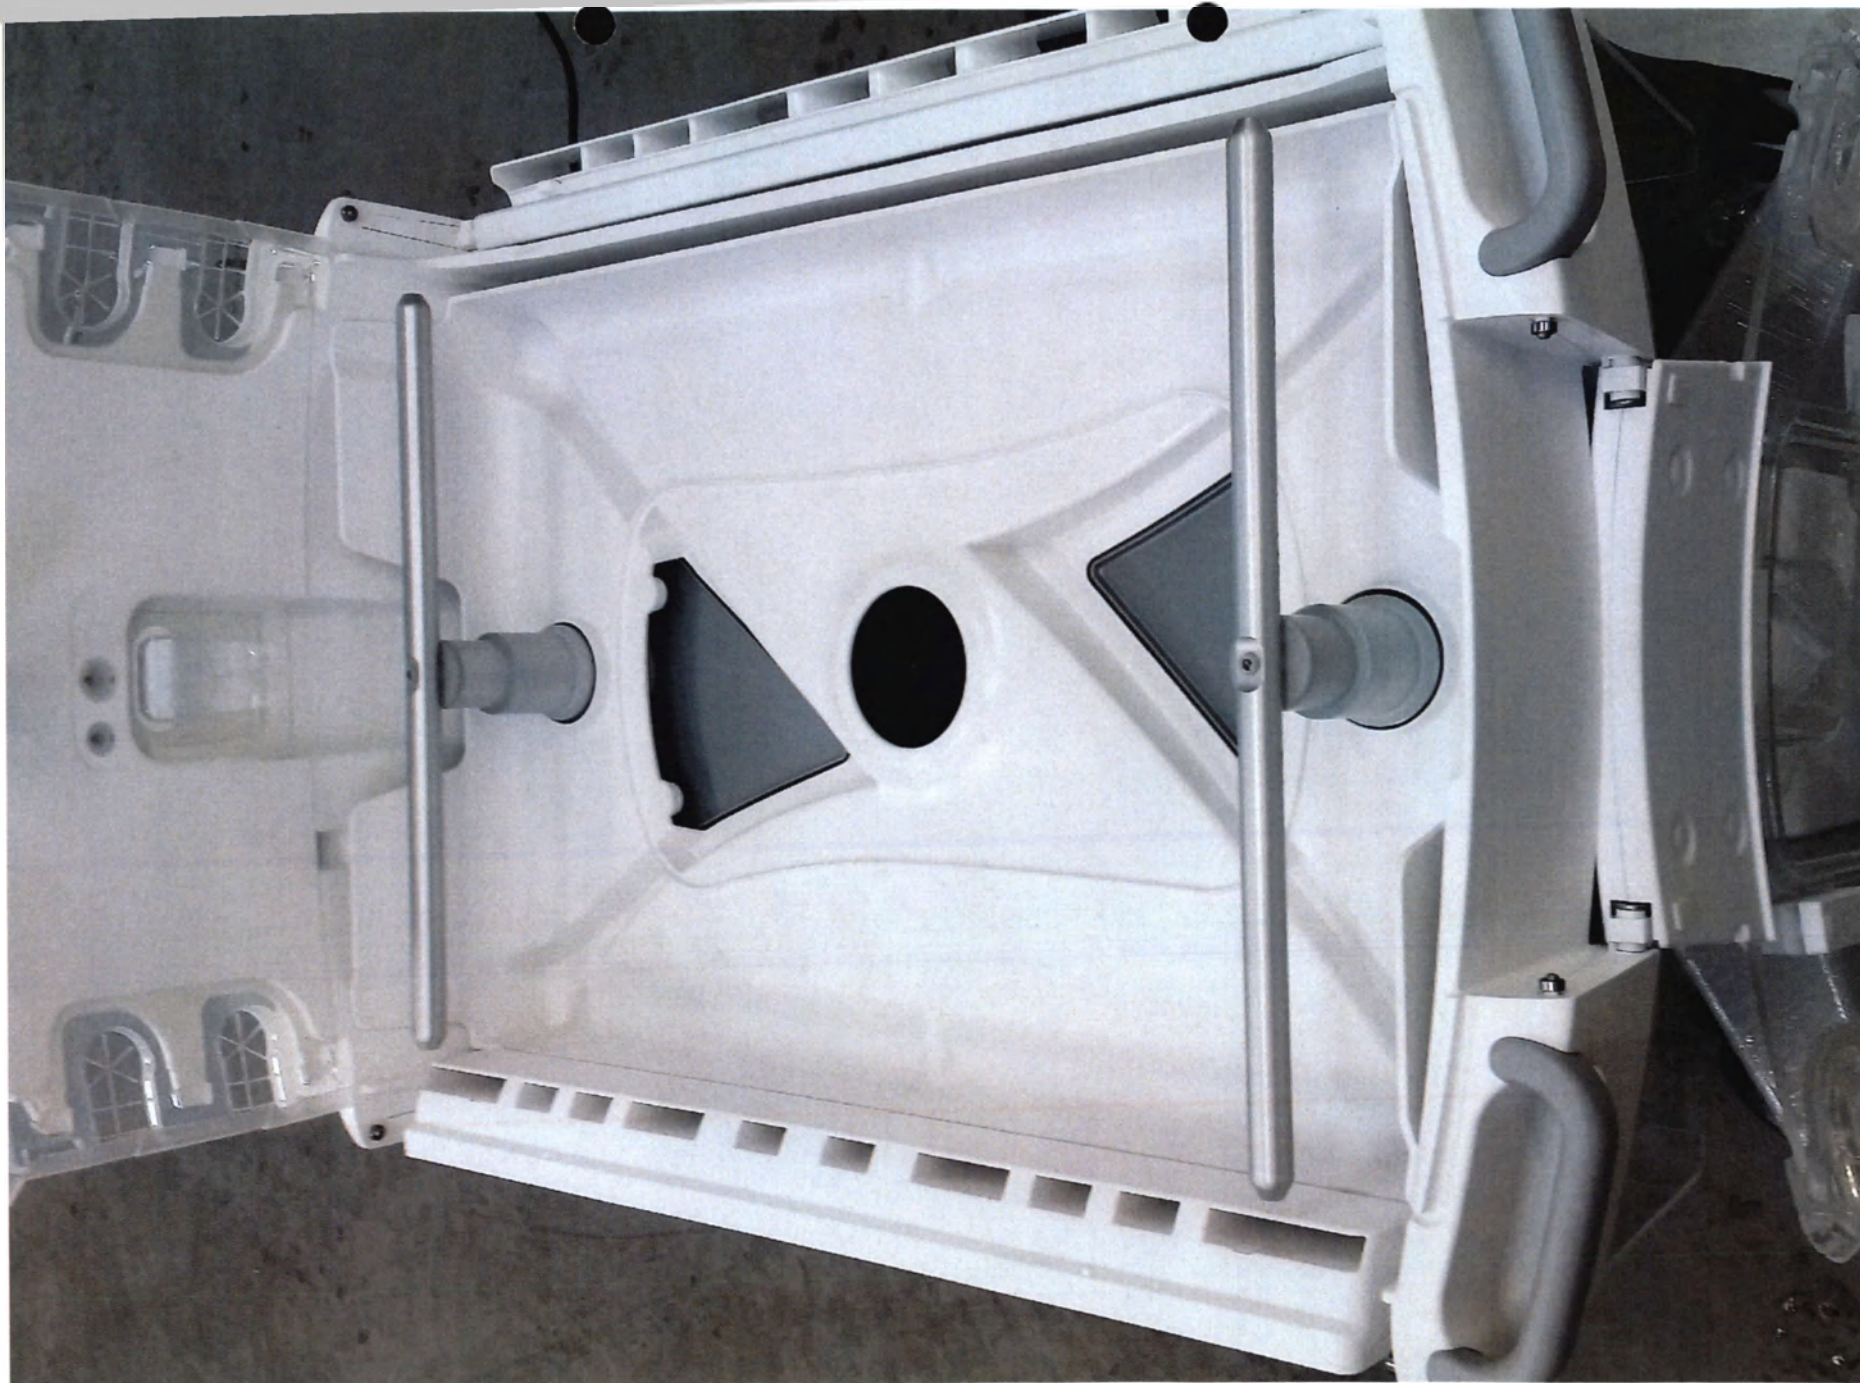


Блок измерения веса ребёнка (устанавливается во внутреннюю часть)

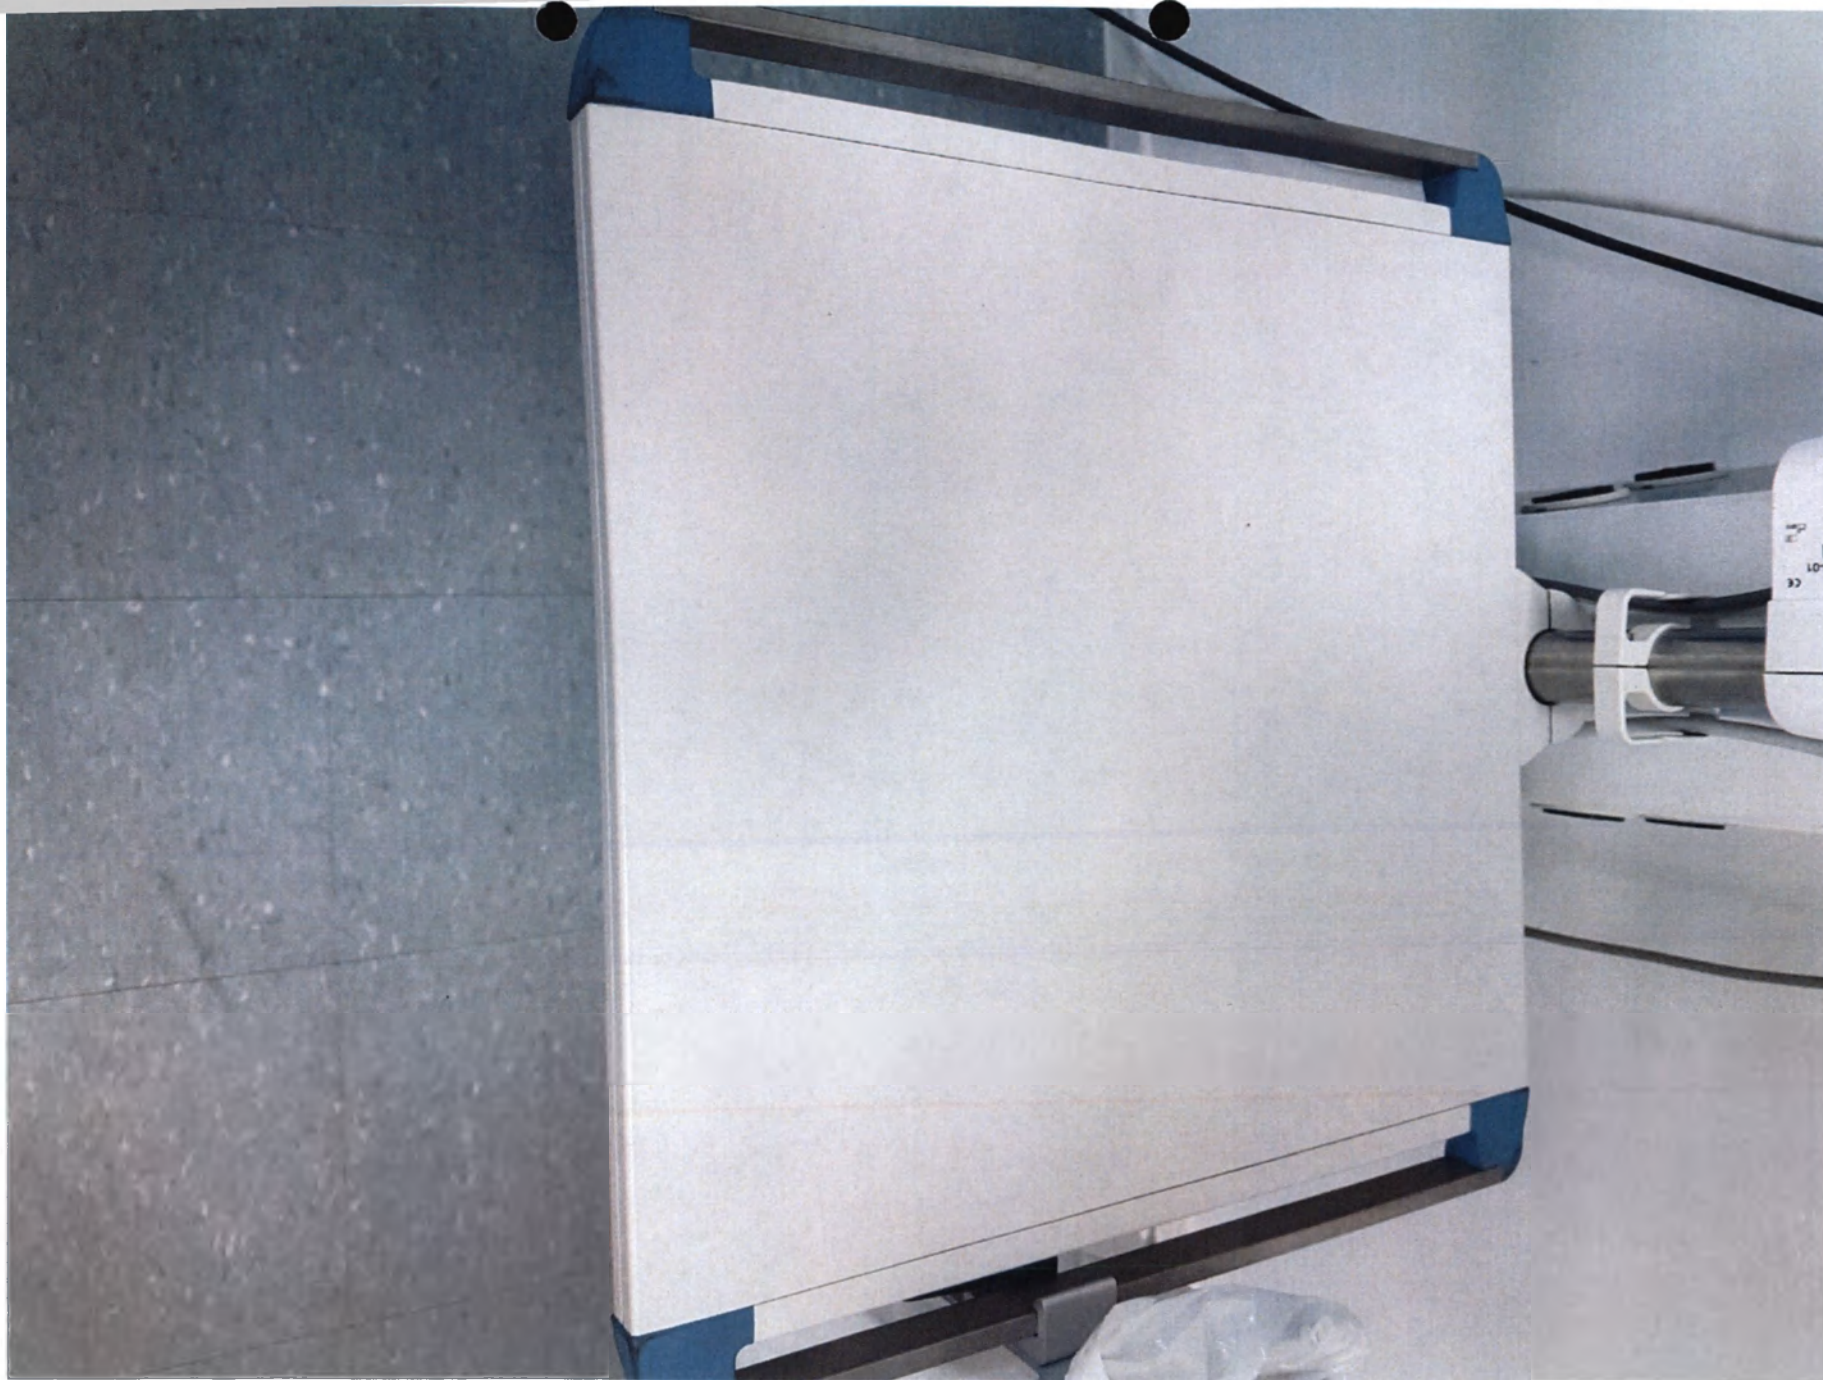

Дополнительная полка

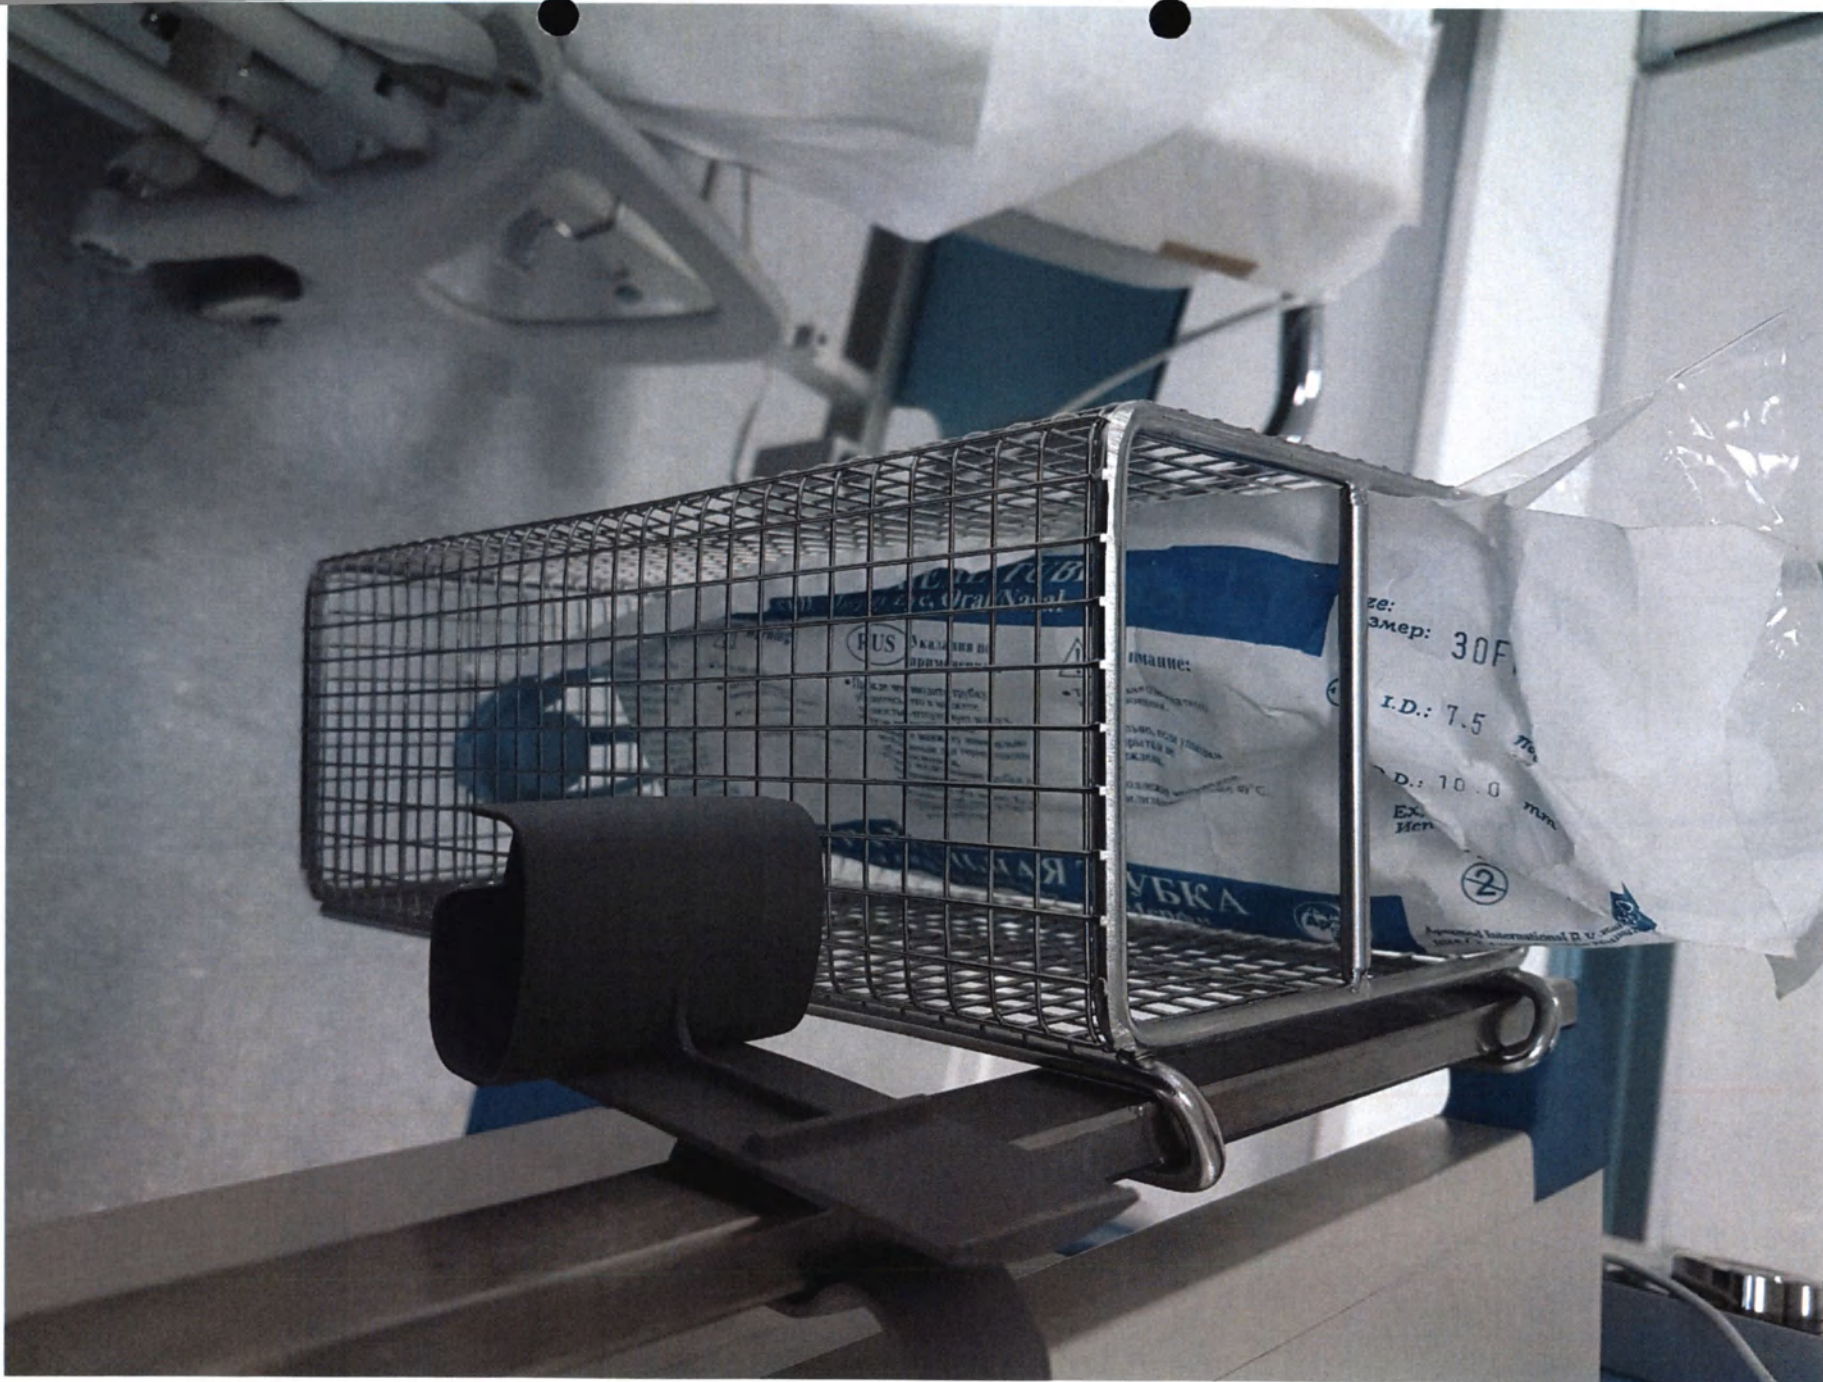


Корзины для принадлежностей

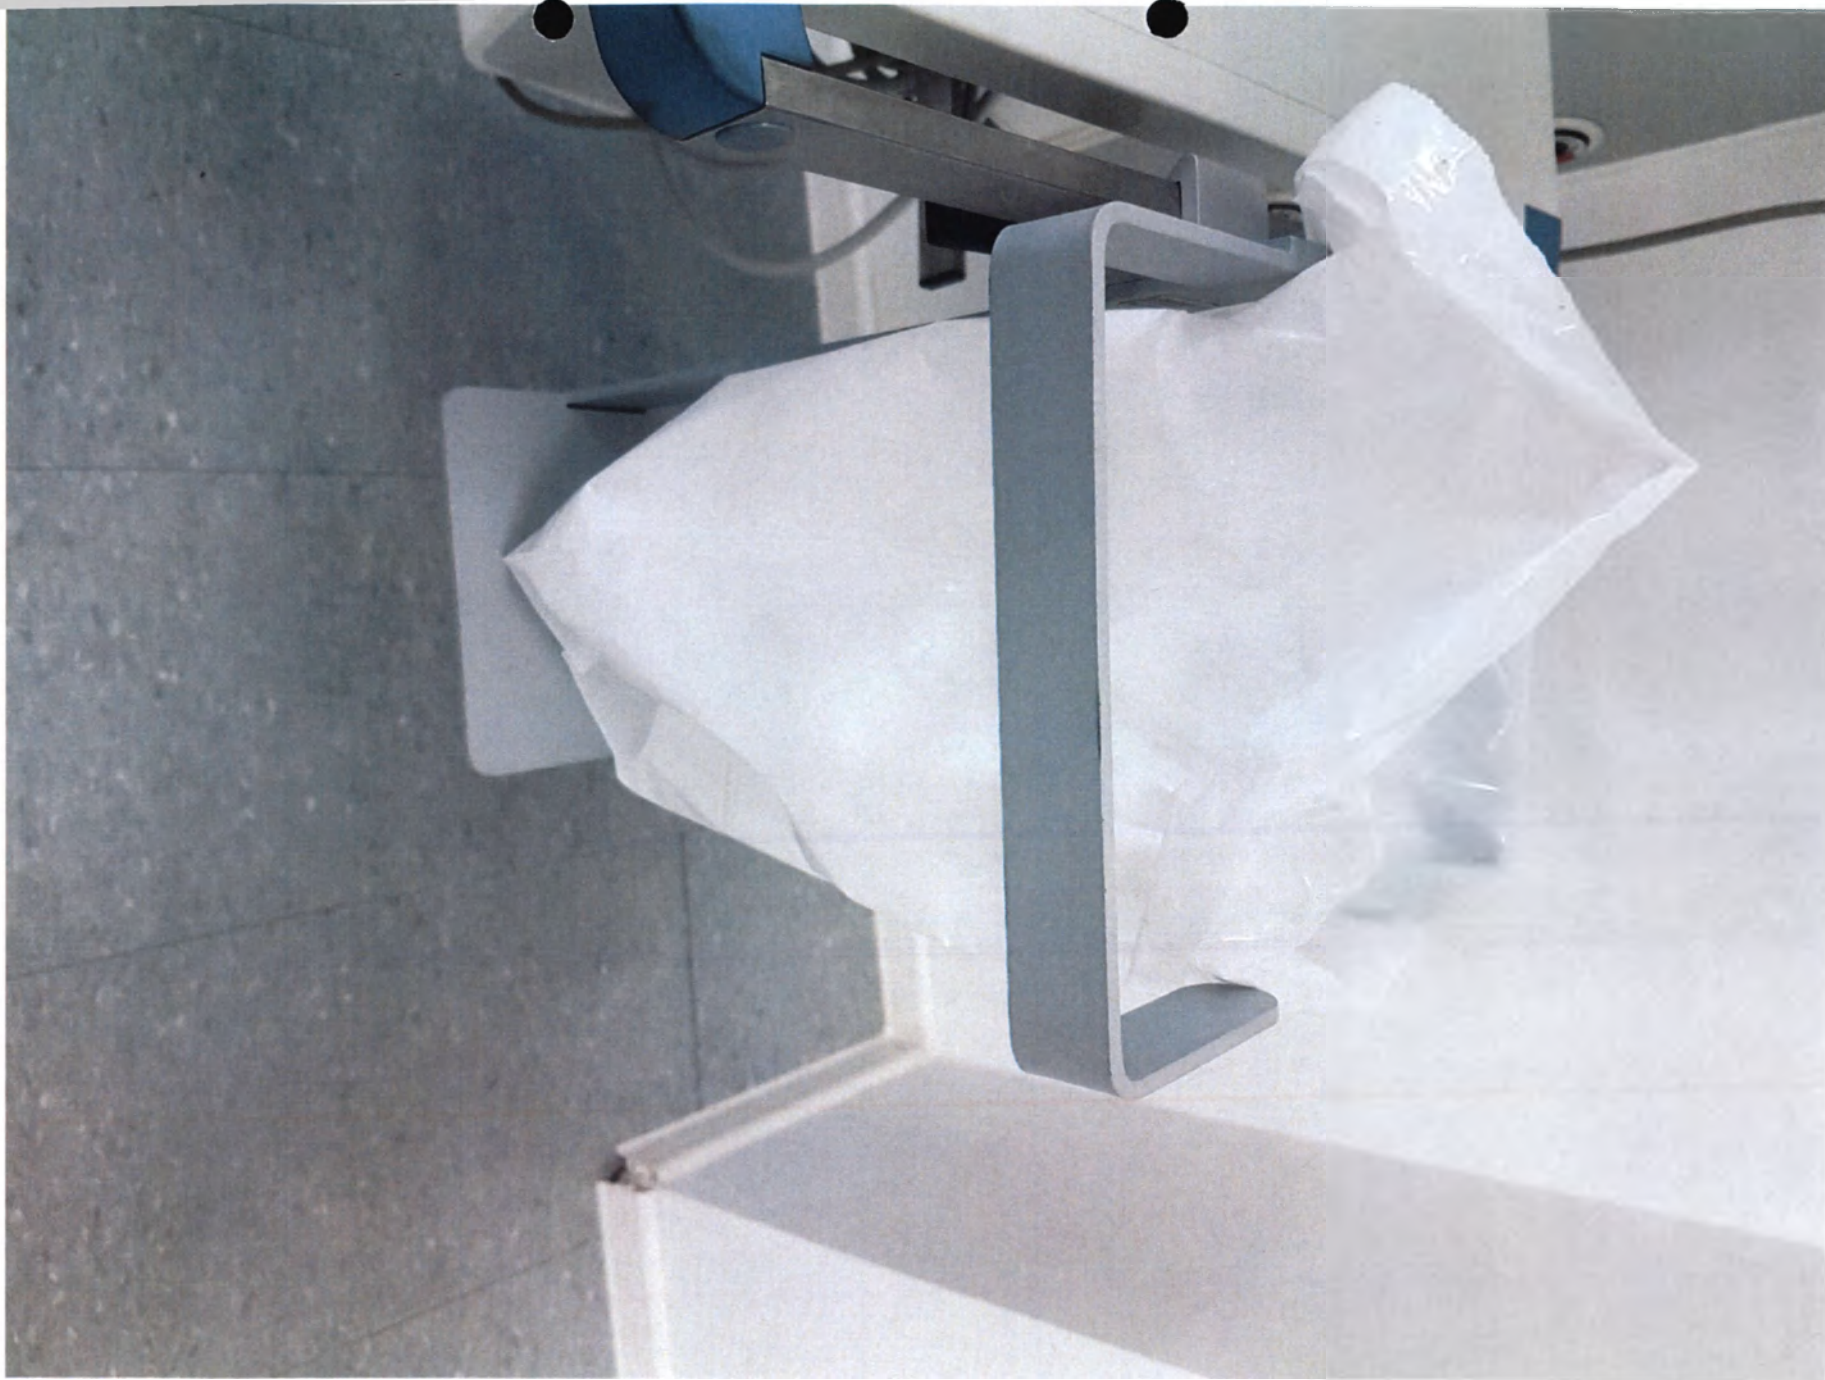


Контейнер для мусорных мешков



Кронштейн для капельницы, вертикальная стойка

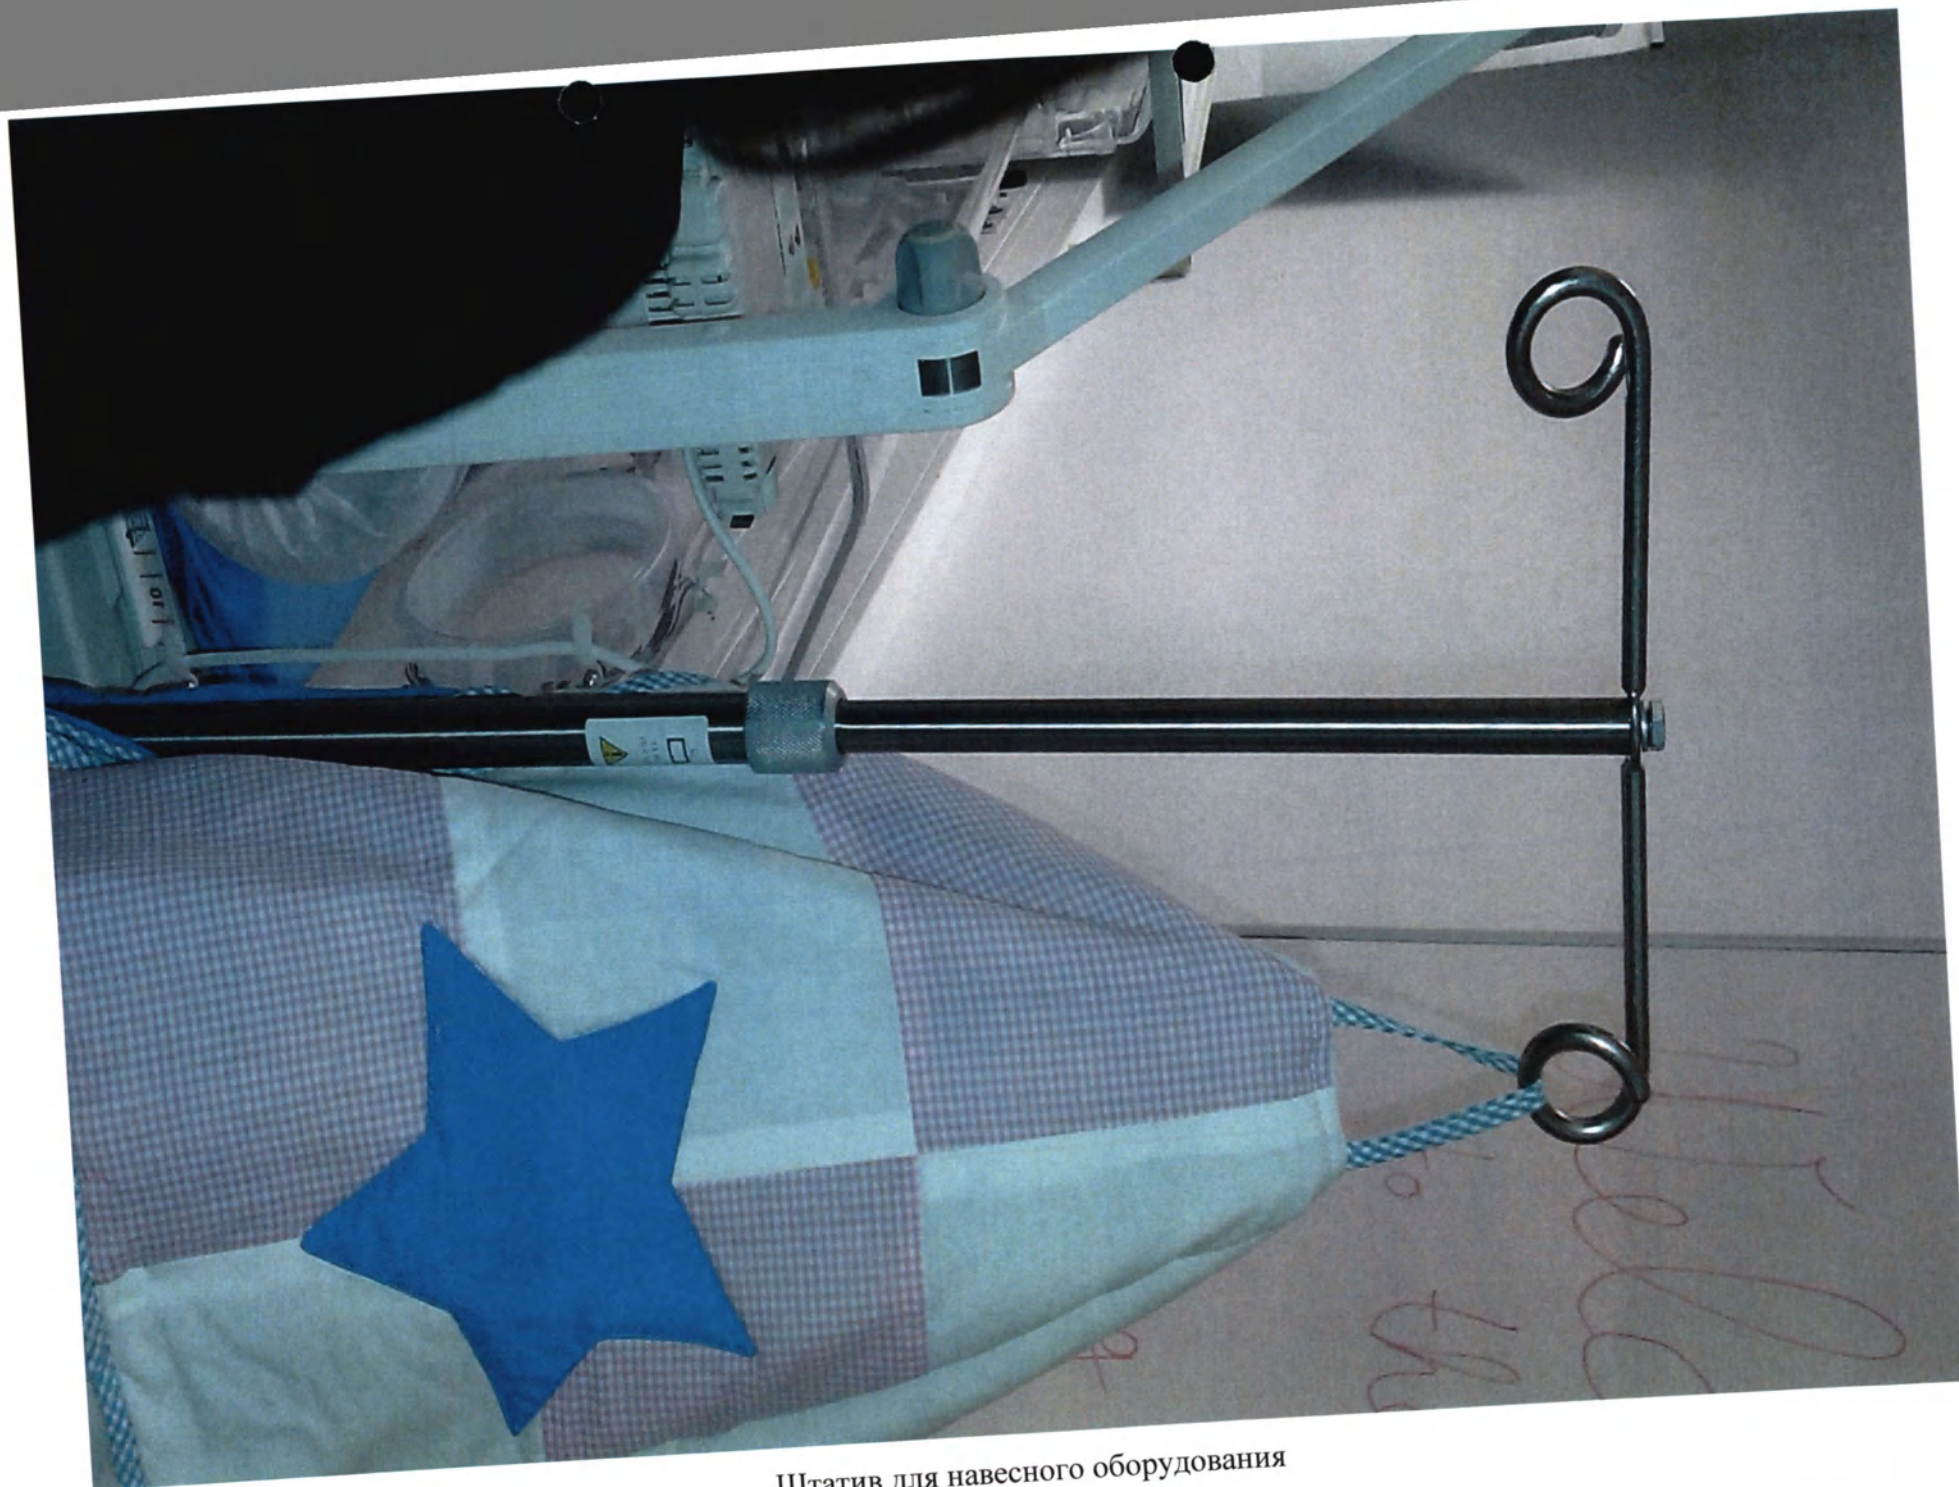

Штатив для навесного оборудования

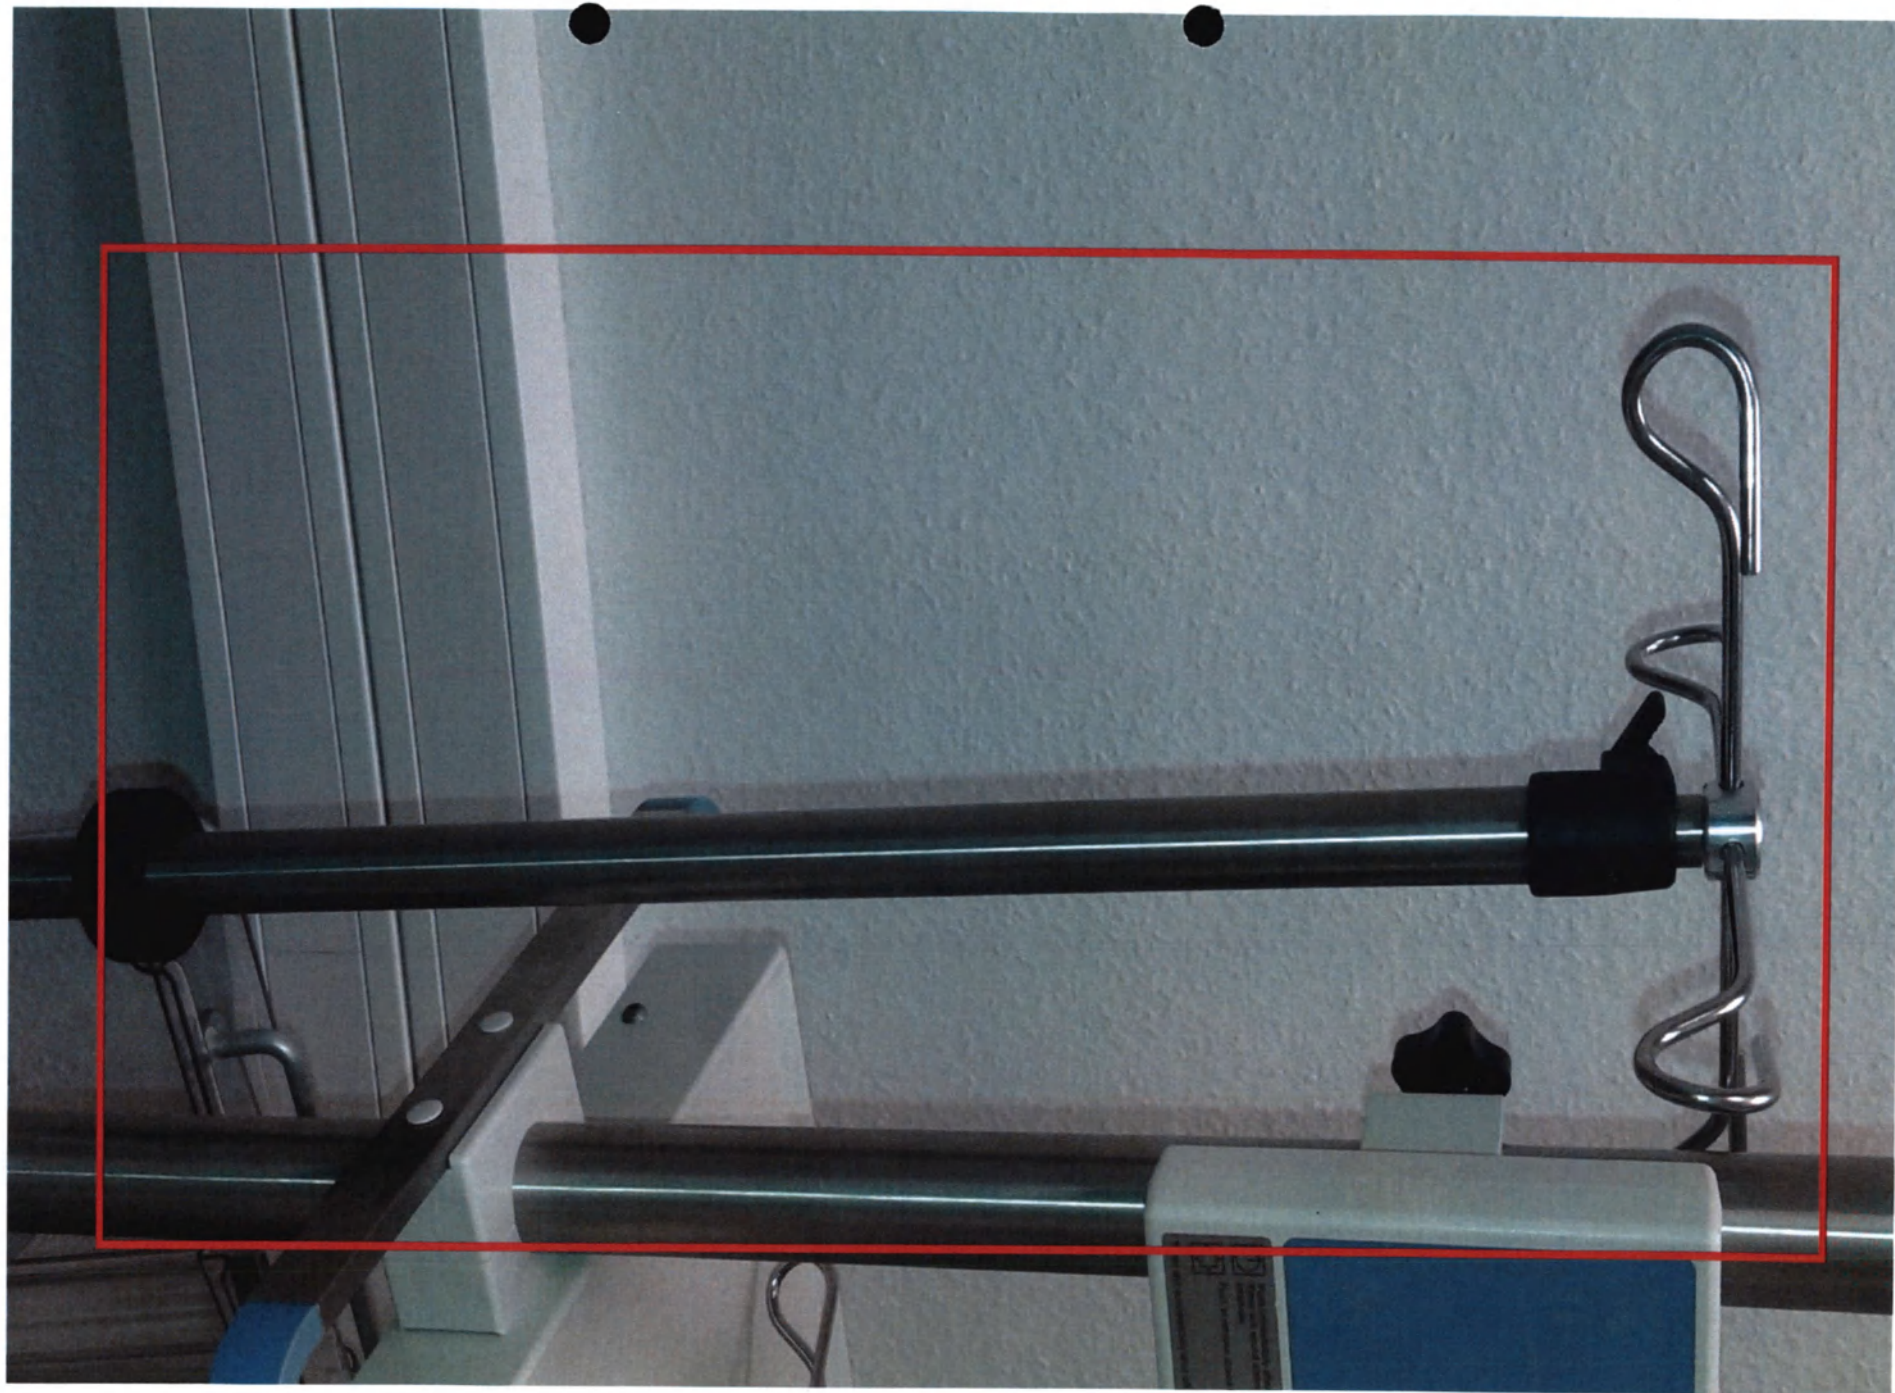


Штатив для внутривенных вливаний




Кронштейн крепления монитора пациента




Кронштейн крепления монитора пациента с динамическим изменением положения и высоты

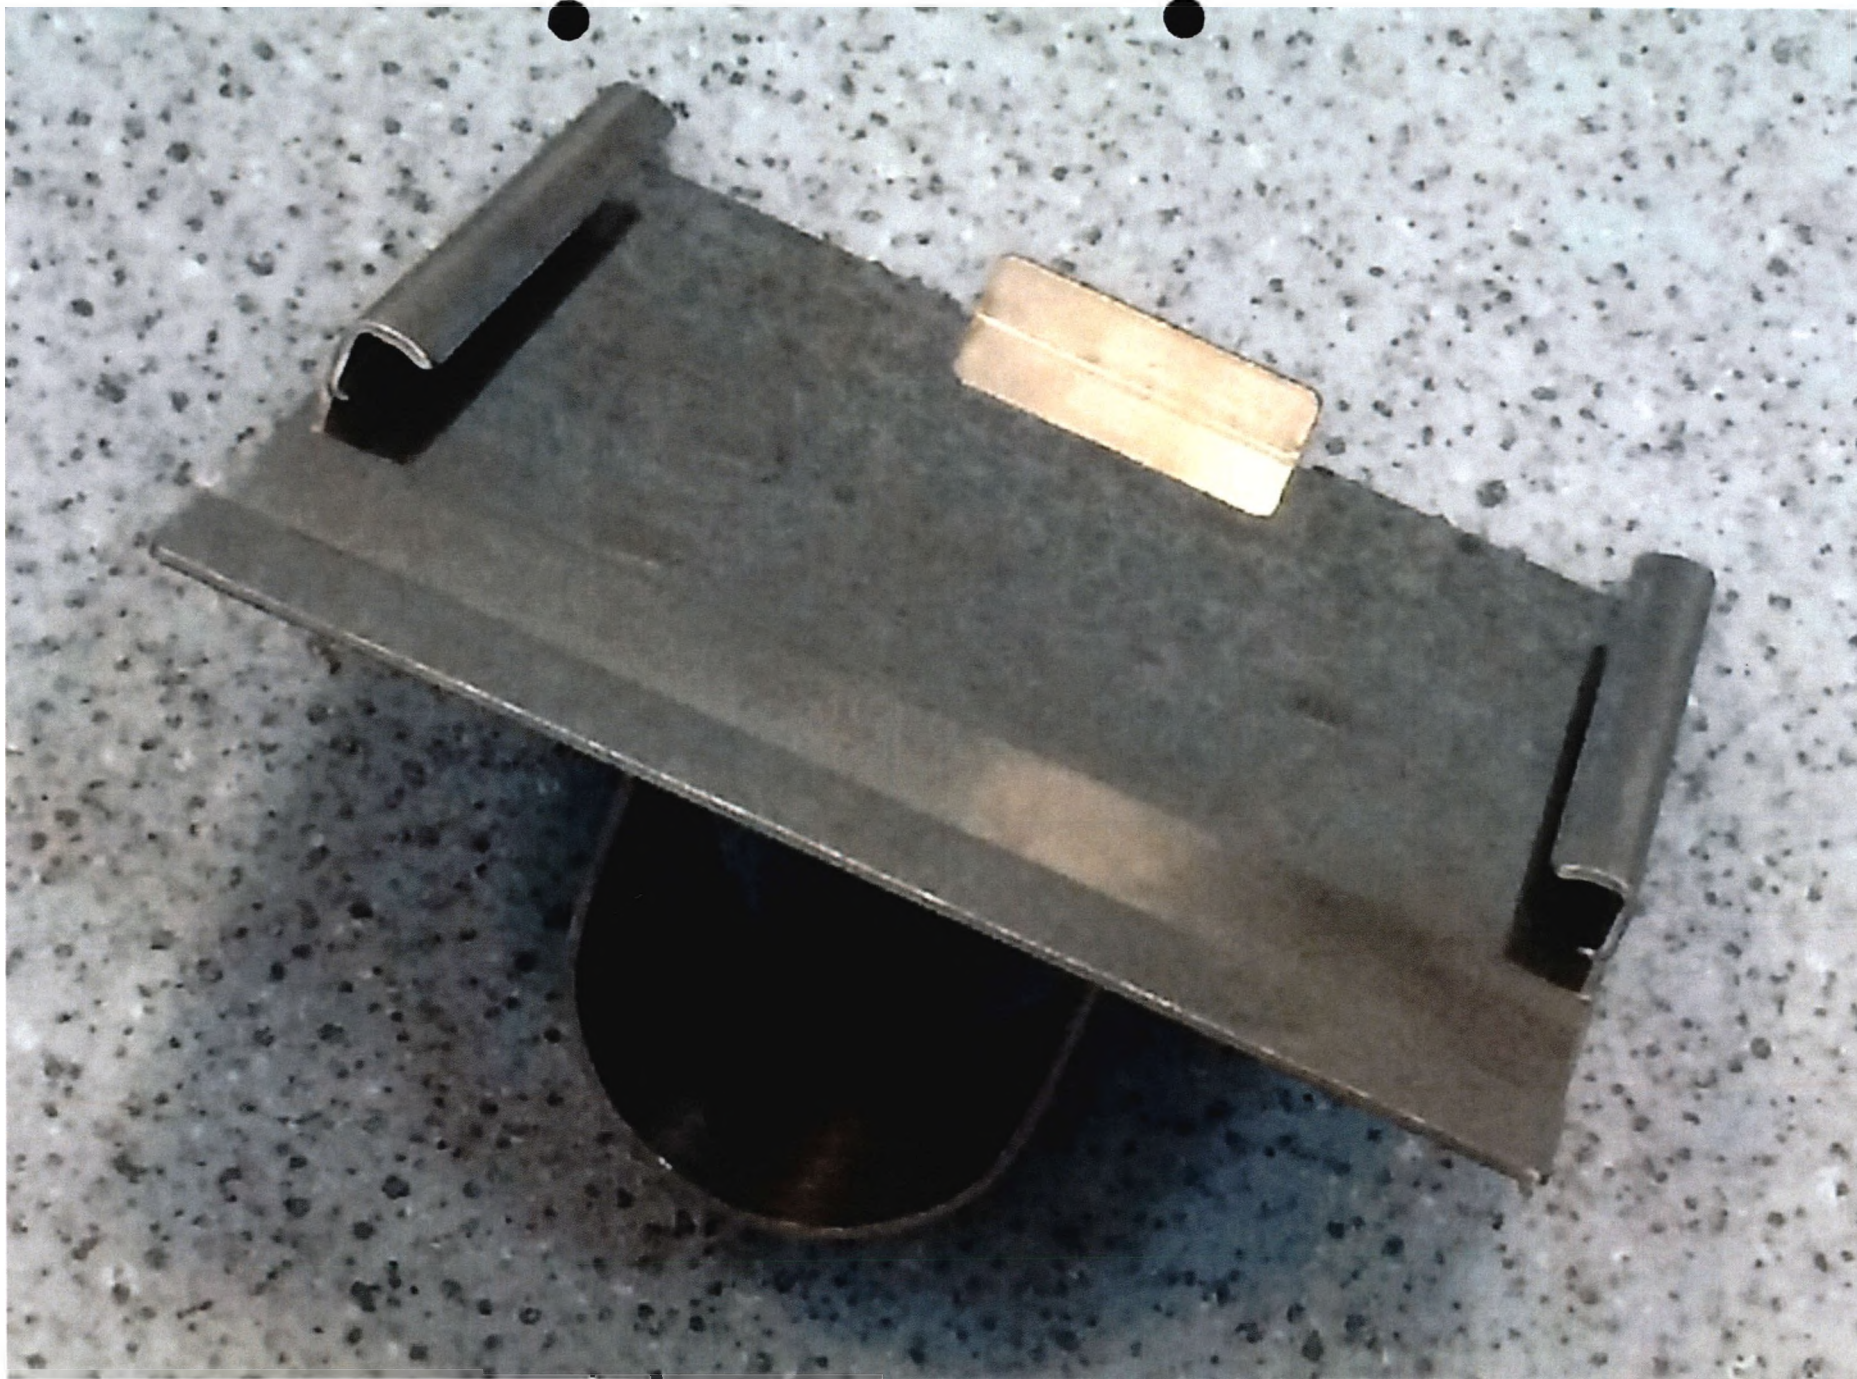


Кронштейн крепления блока питания монитора пациента

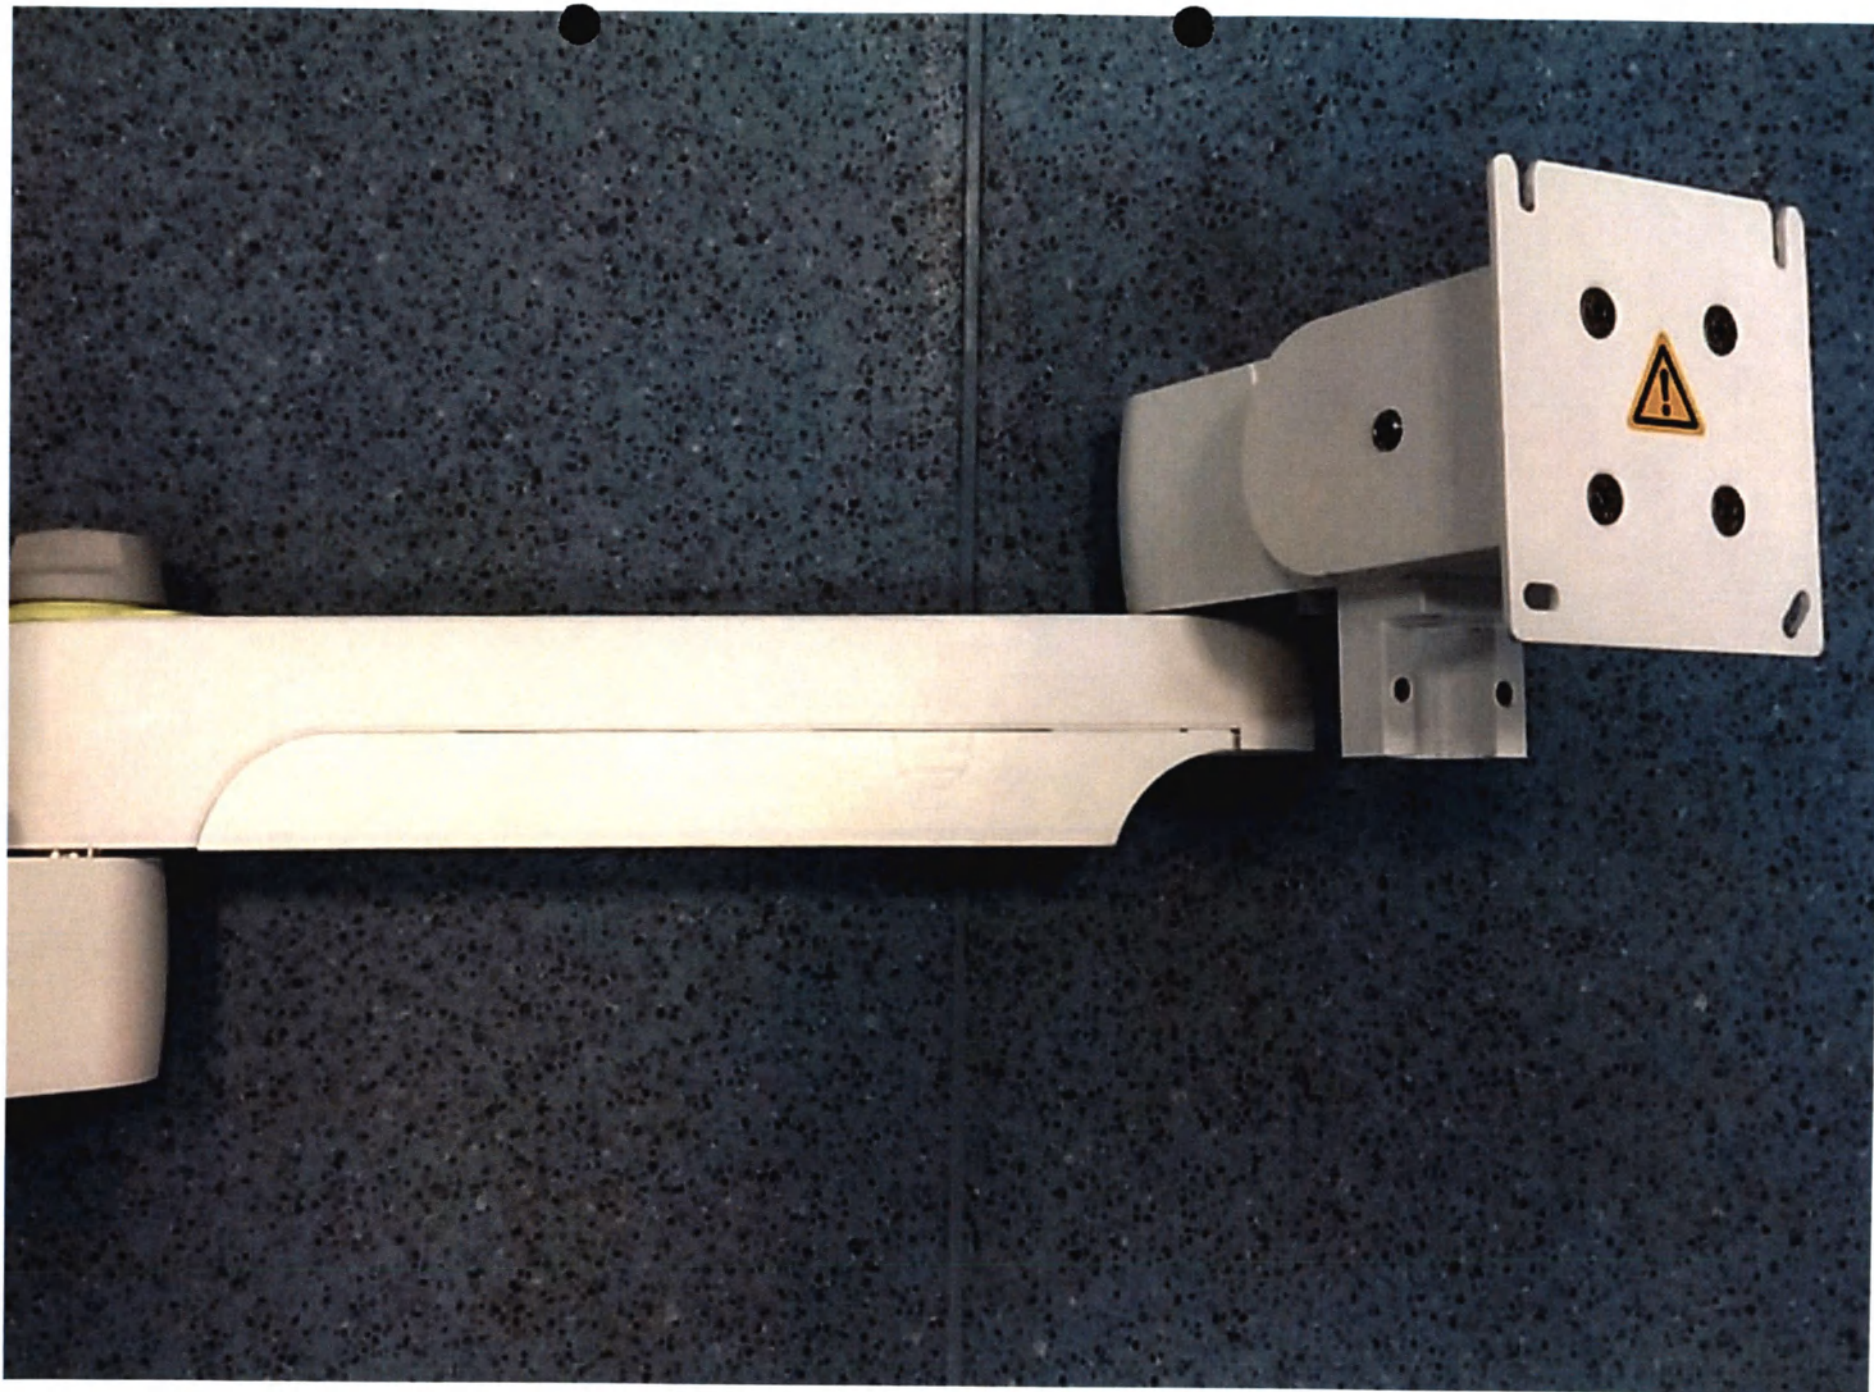

Кронштейн крепления дисплея с монтажным интерфейсом стандарта VESA

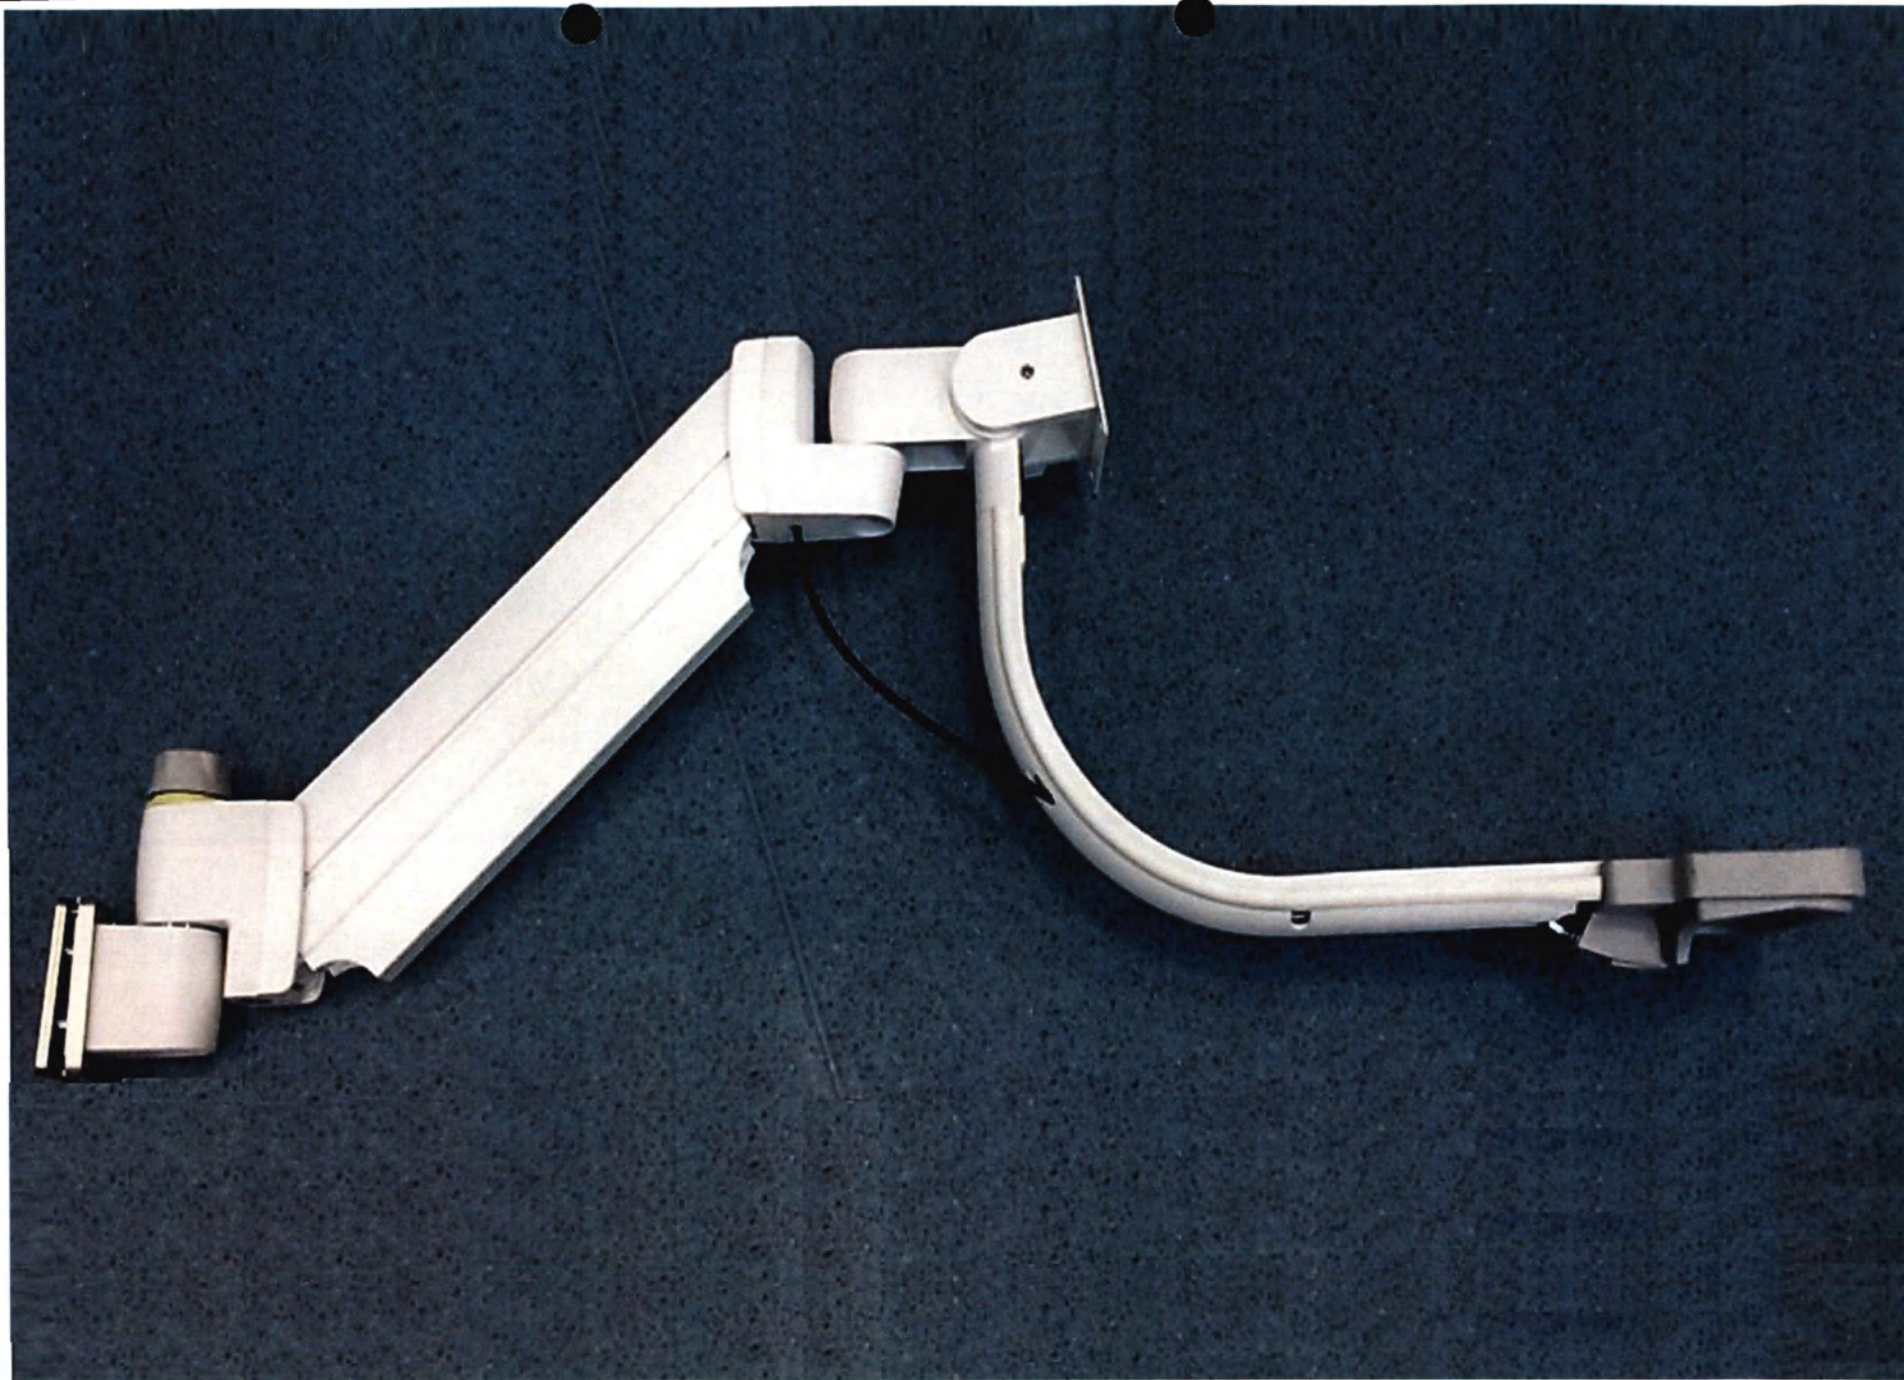


Кронштейн крепления дисплея с монтажным интерфейсом стандарта VESA с динамическим изменением положения и высоты

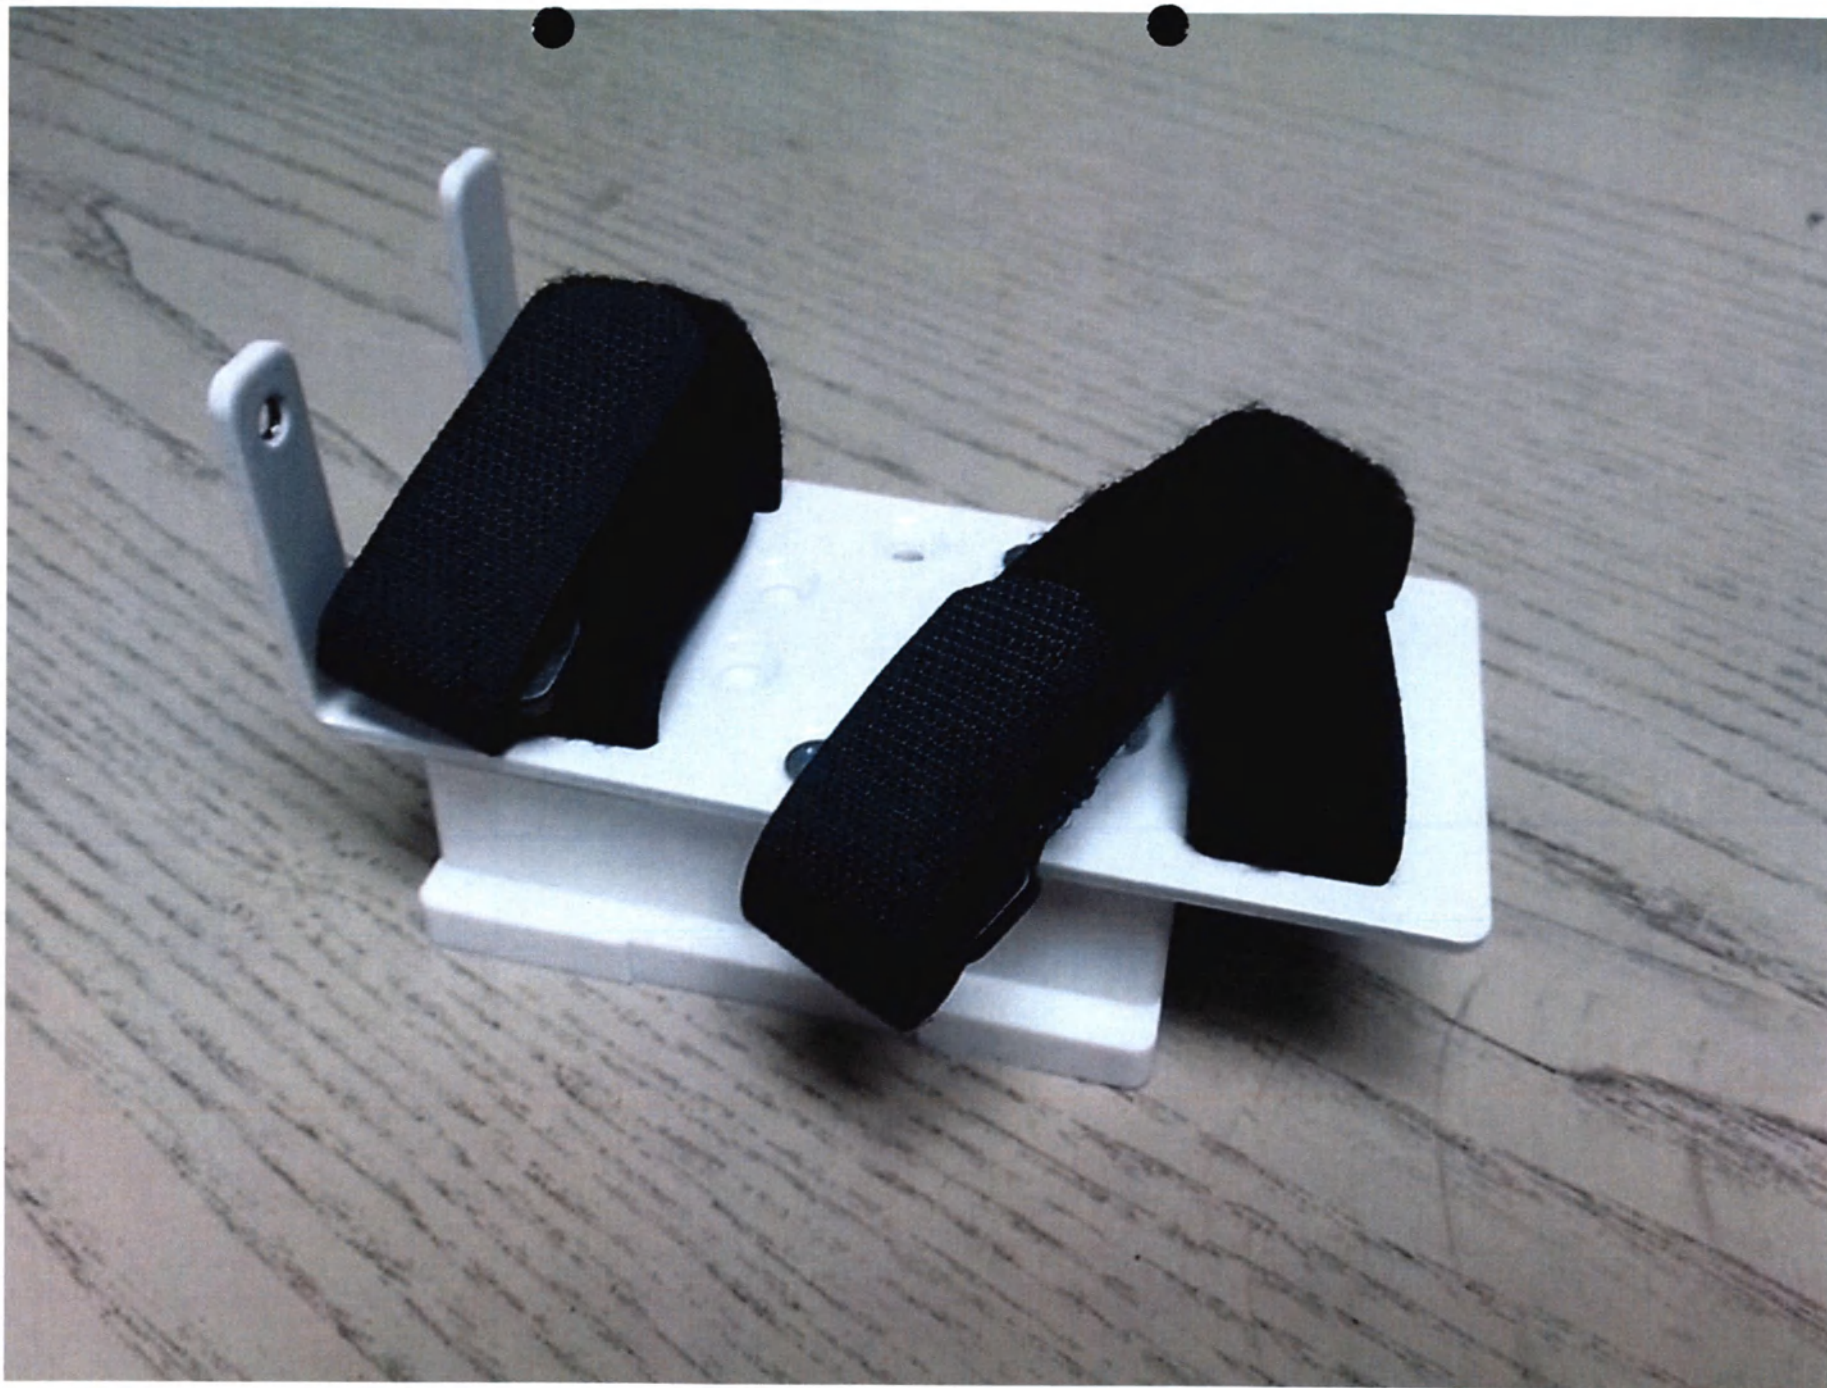

Кронштейн крепления блока питания дисплея



Держатель соединительного шланга

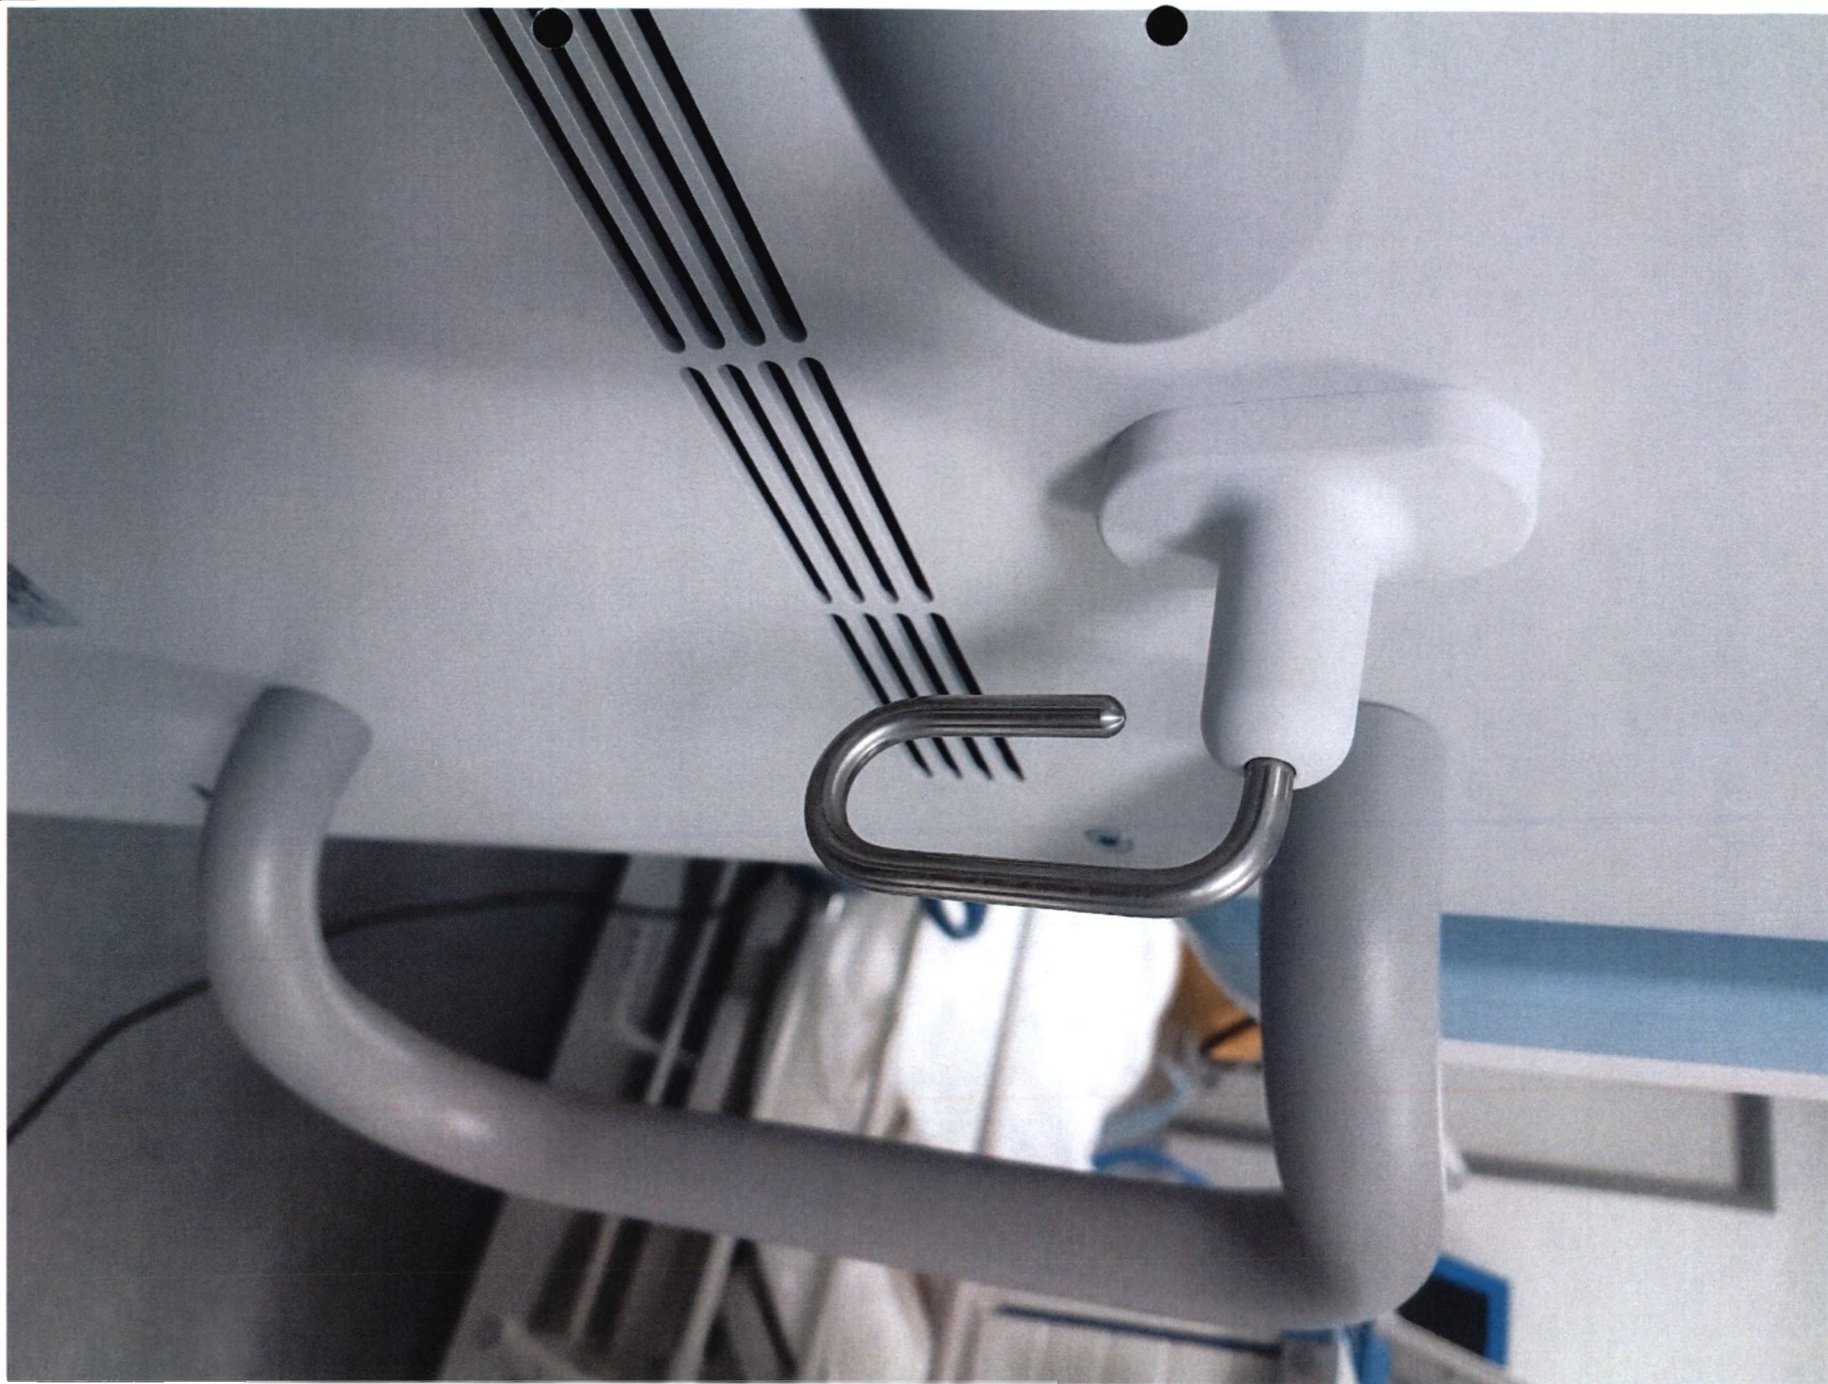


Держатель-крючок



Валик для позиционирования ребёнка, многоразовый



Укладка-гнездышко для позиционирования ребёнка, многоразовое

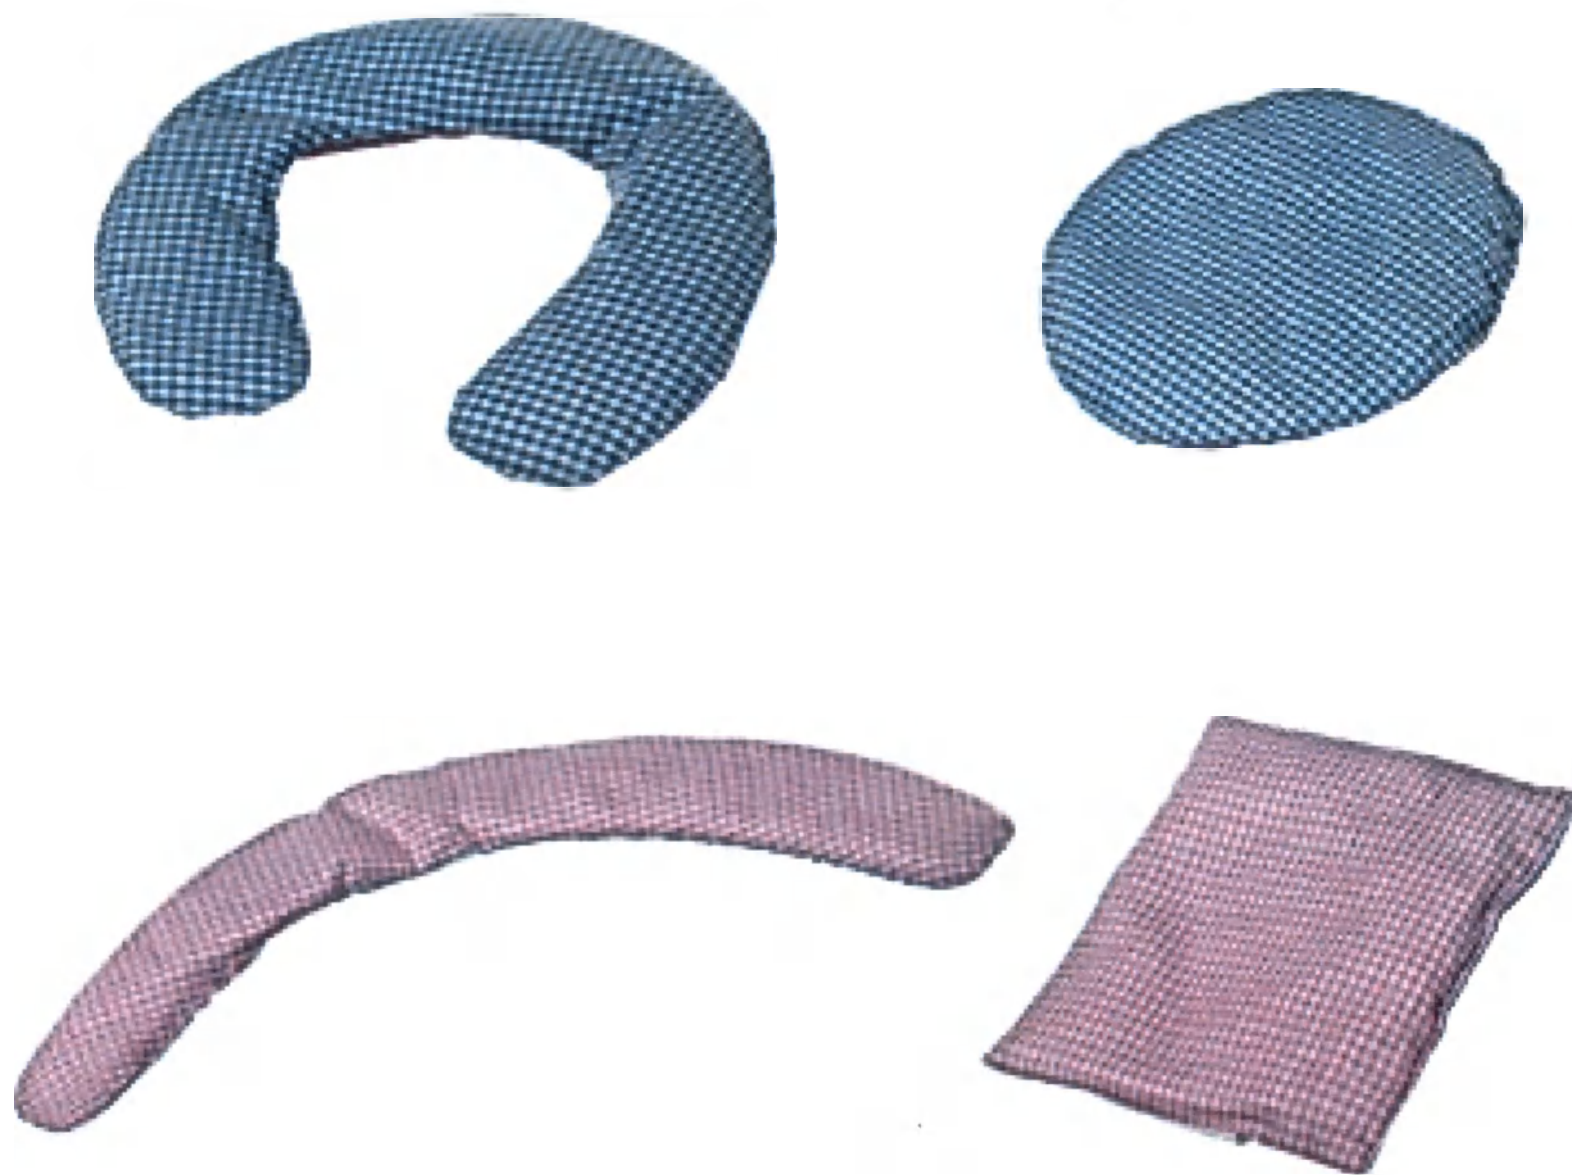

Набор для позиционирования ребёнка (валики и укладки)




Покрывало для TN500



Датчик центральной температуры ThermoTrac



Датчик периферической температуры ThermoTrace

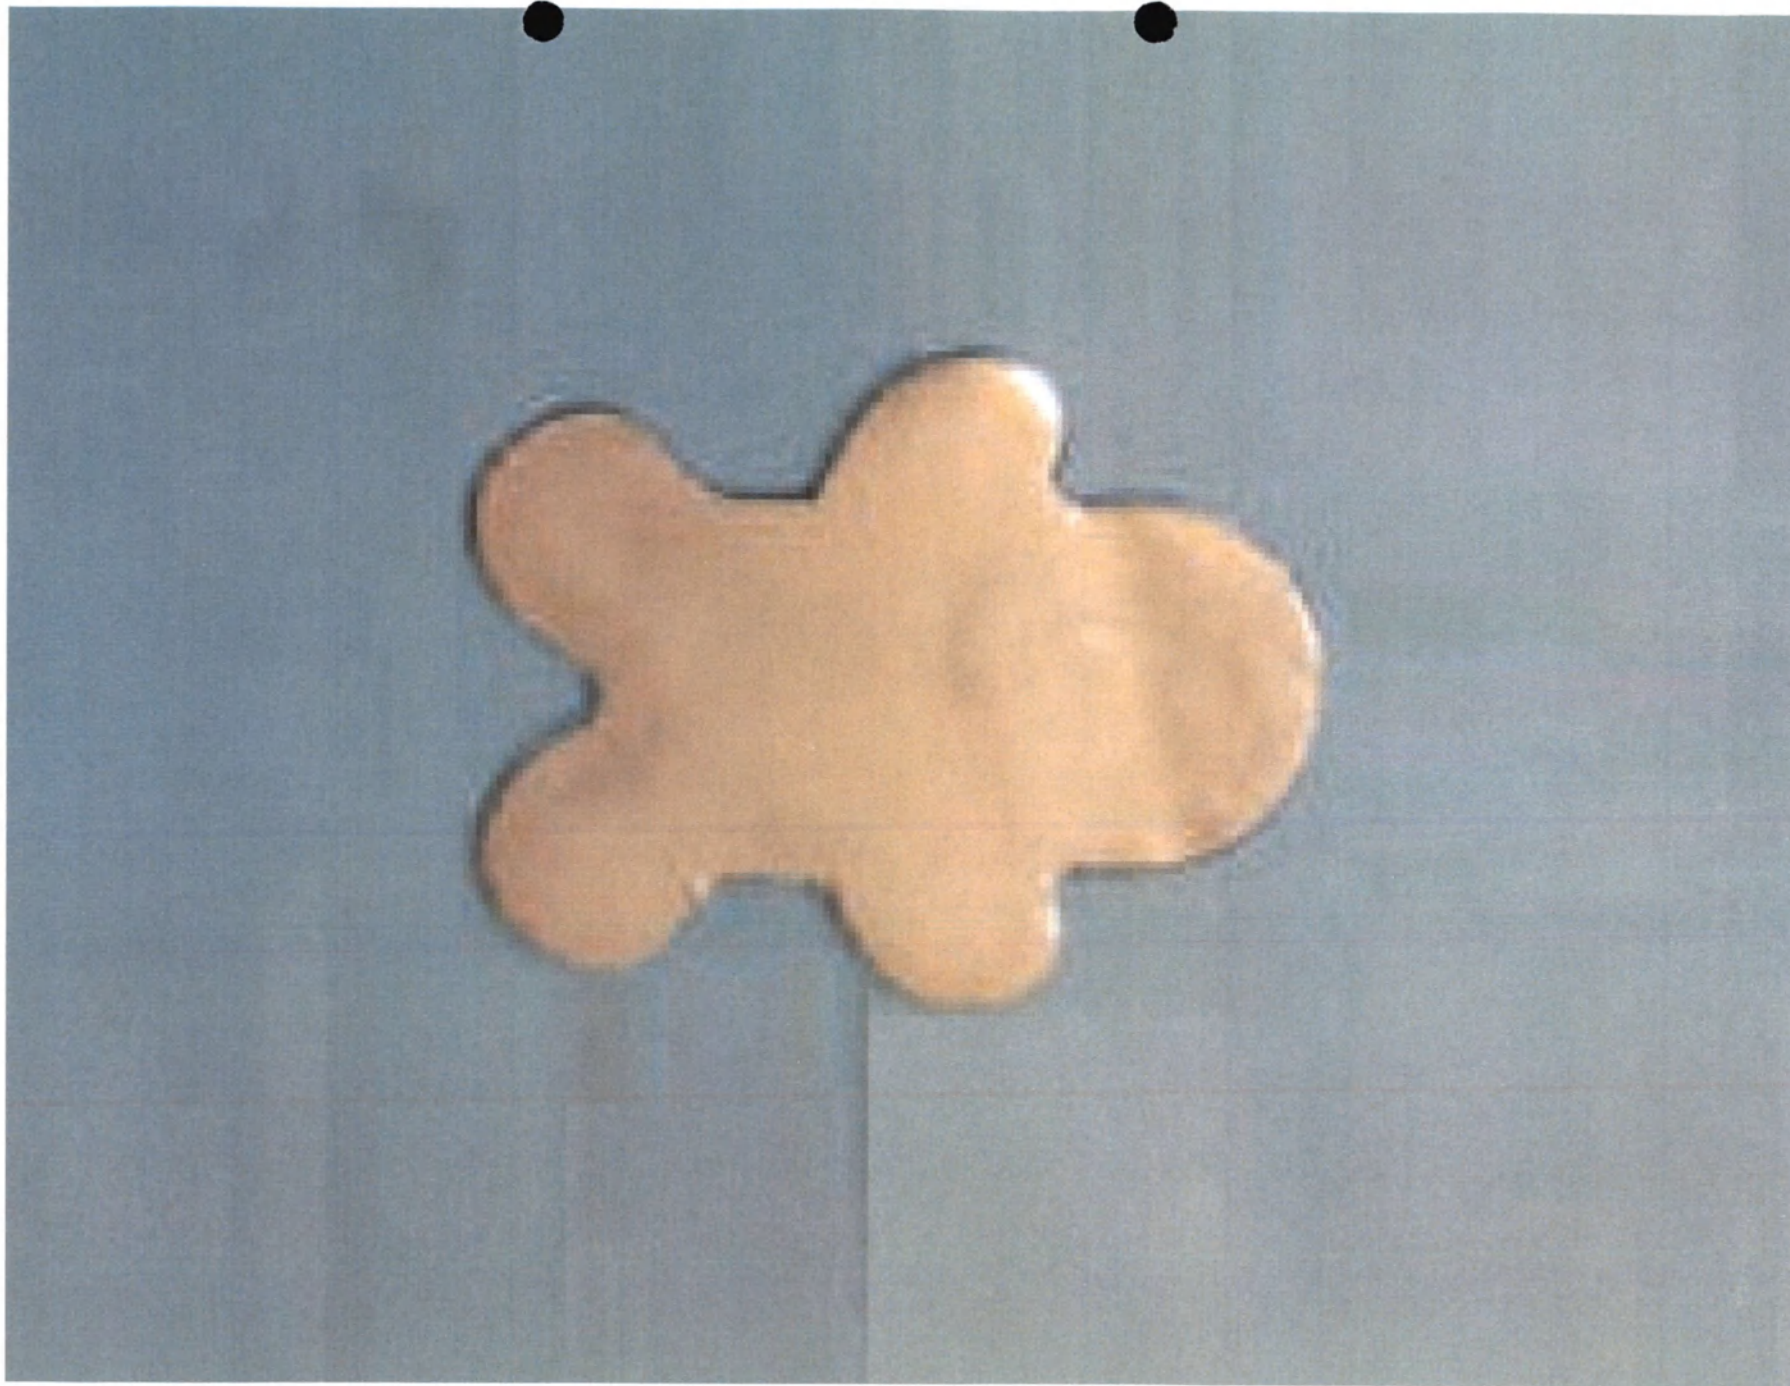

Теплоотражающая наклейка датчика температуры кожи Care-For-Me, большого/обычного размера

Caution!

CE 0123



Manufacturer
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23542 Lübeck,
Germany



Operating instructions




Do not reuse

Distributed by:
Draeger Medical, Inc.
5 Quarry Road
PA
42



Теплоотражающая наклейка ThermoPad

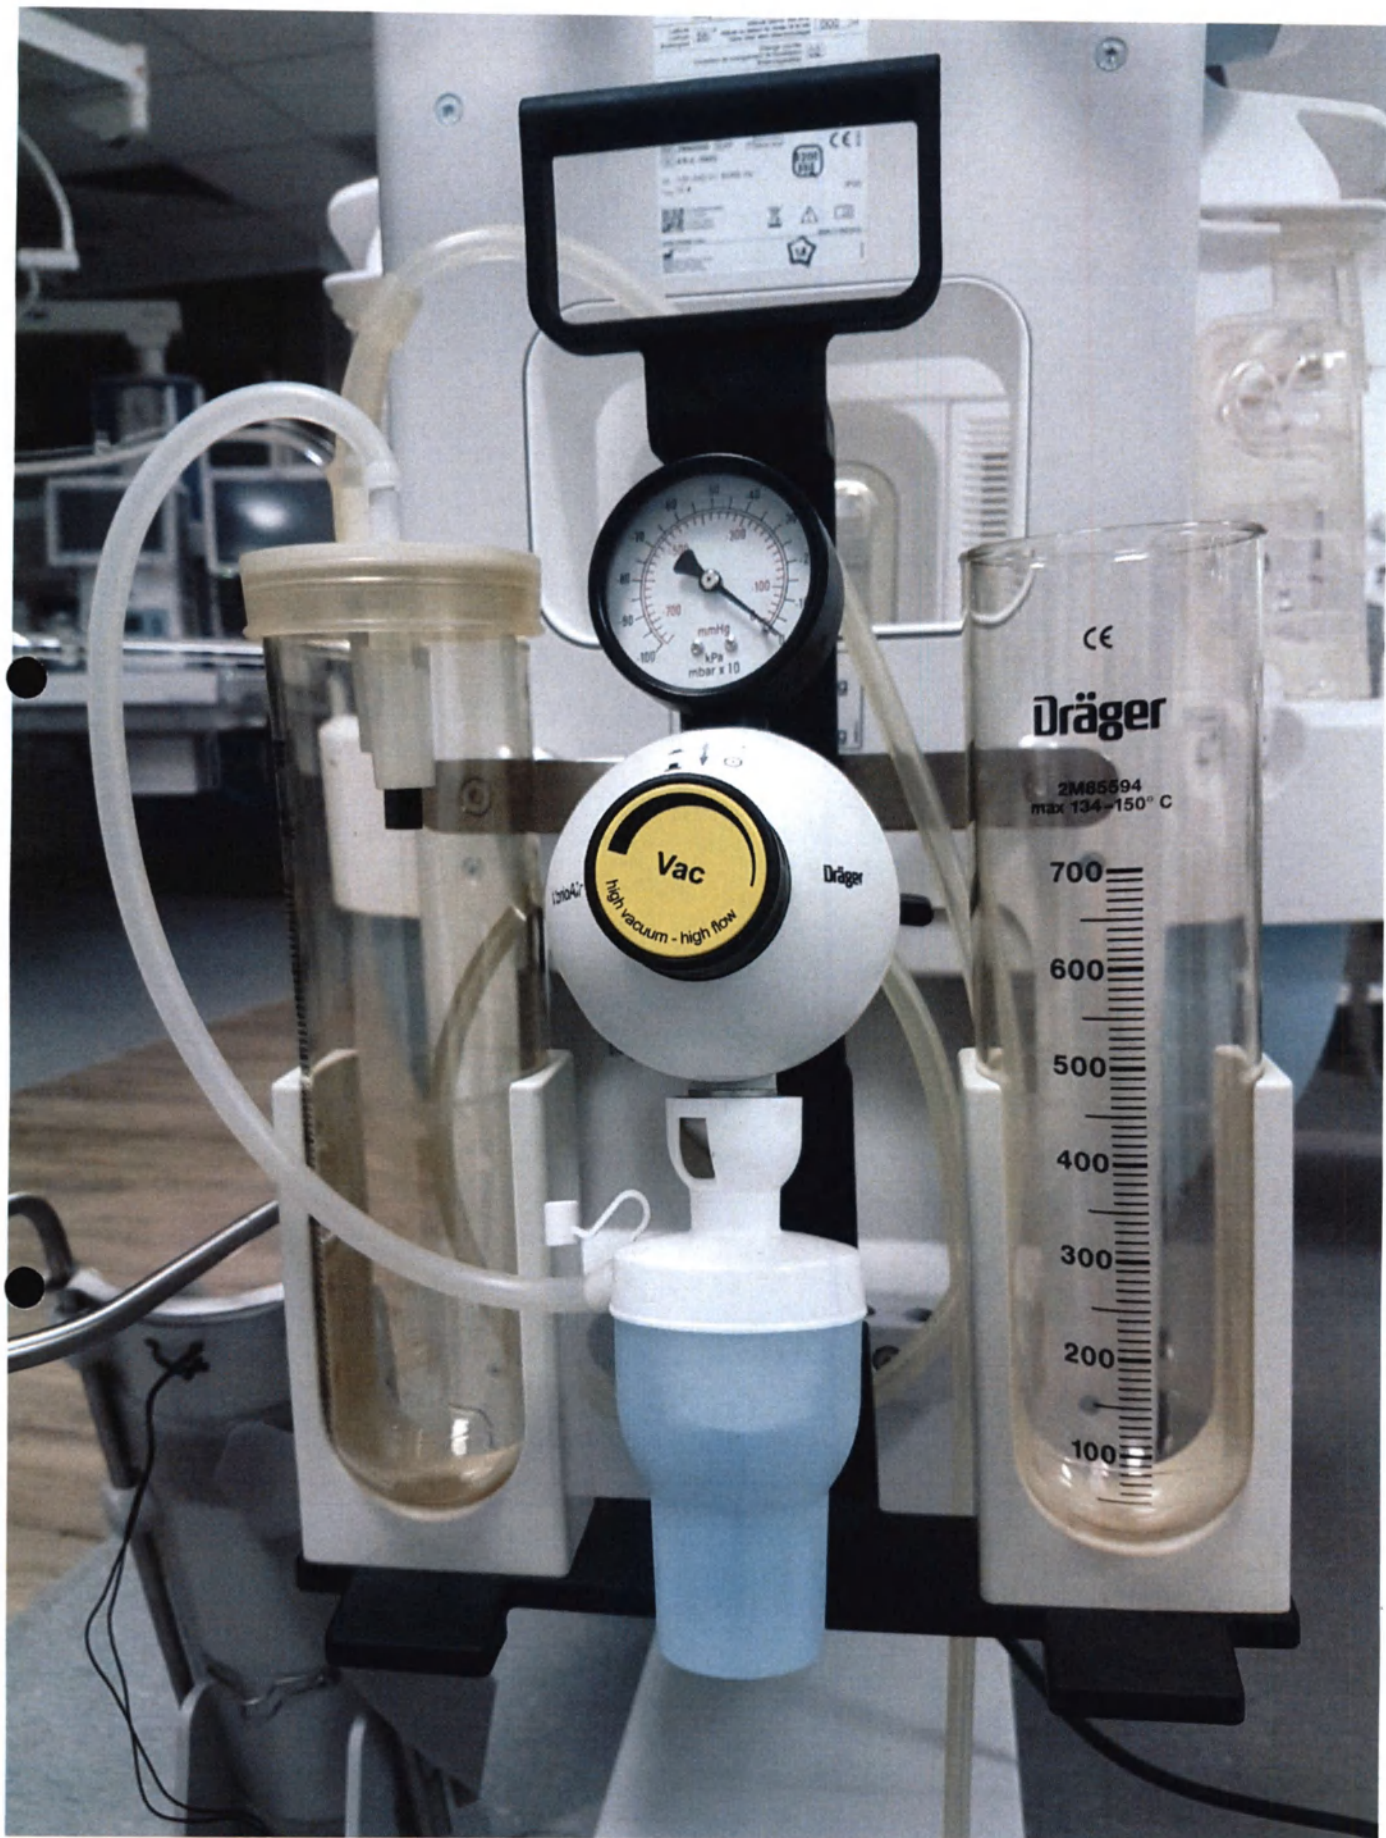

Бронхоаспиратор



Держатель баллонов для профиля GCX




Матрас SoftBed TN500




Матрас с подогревом для TN500



Держатель дыхательного контура

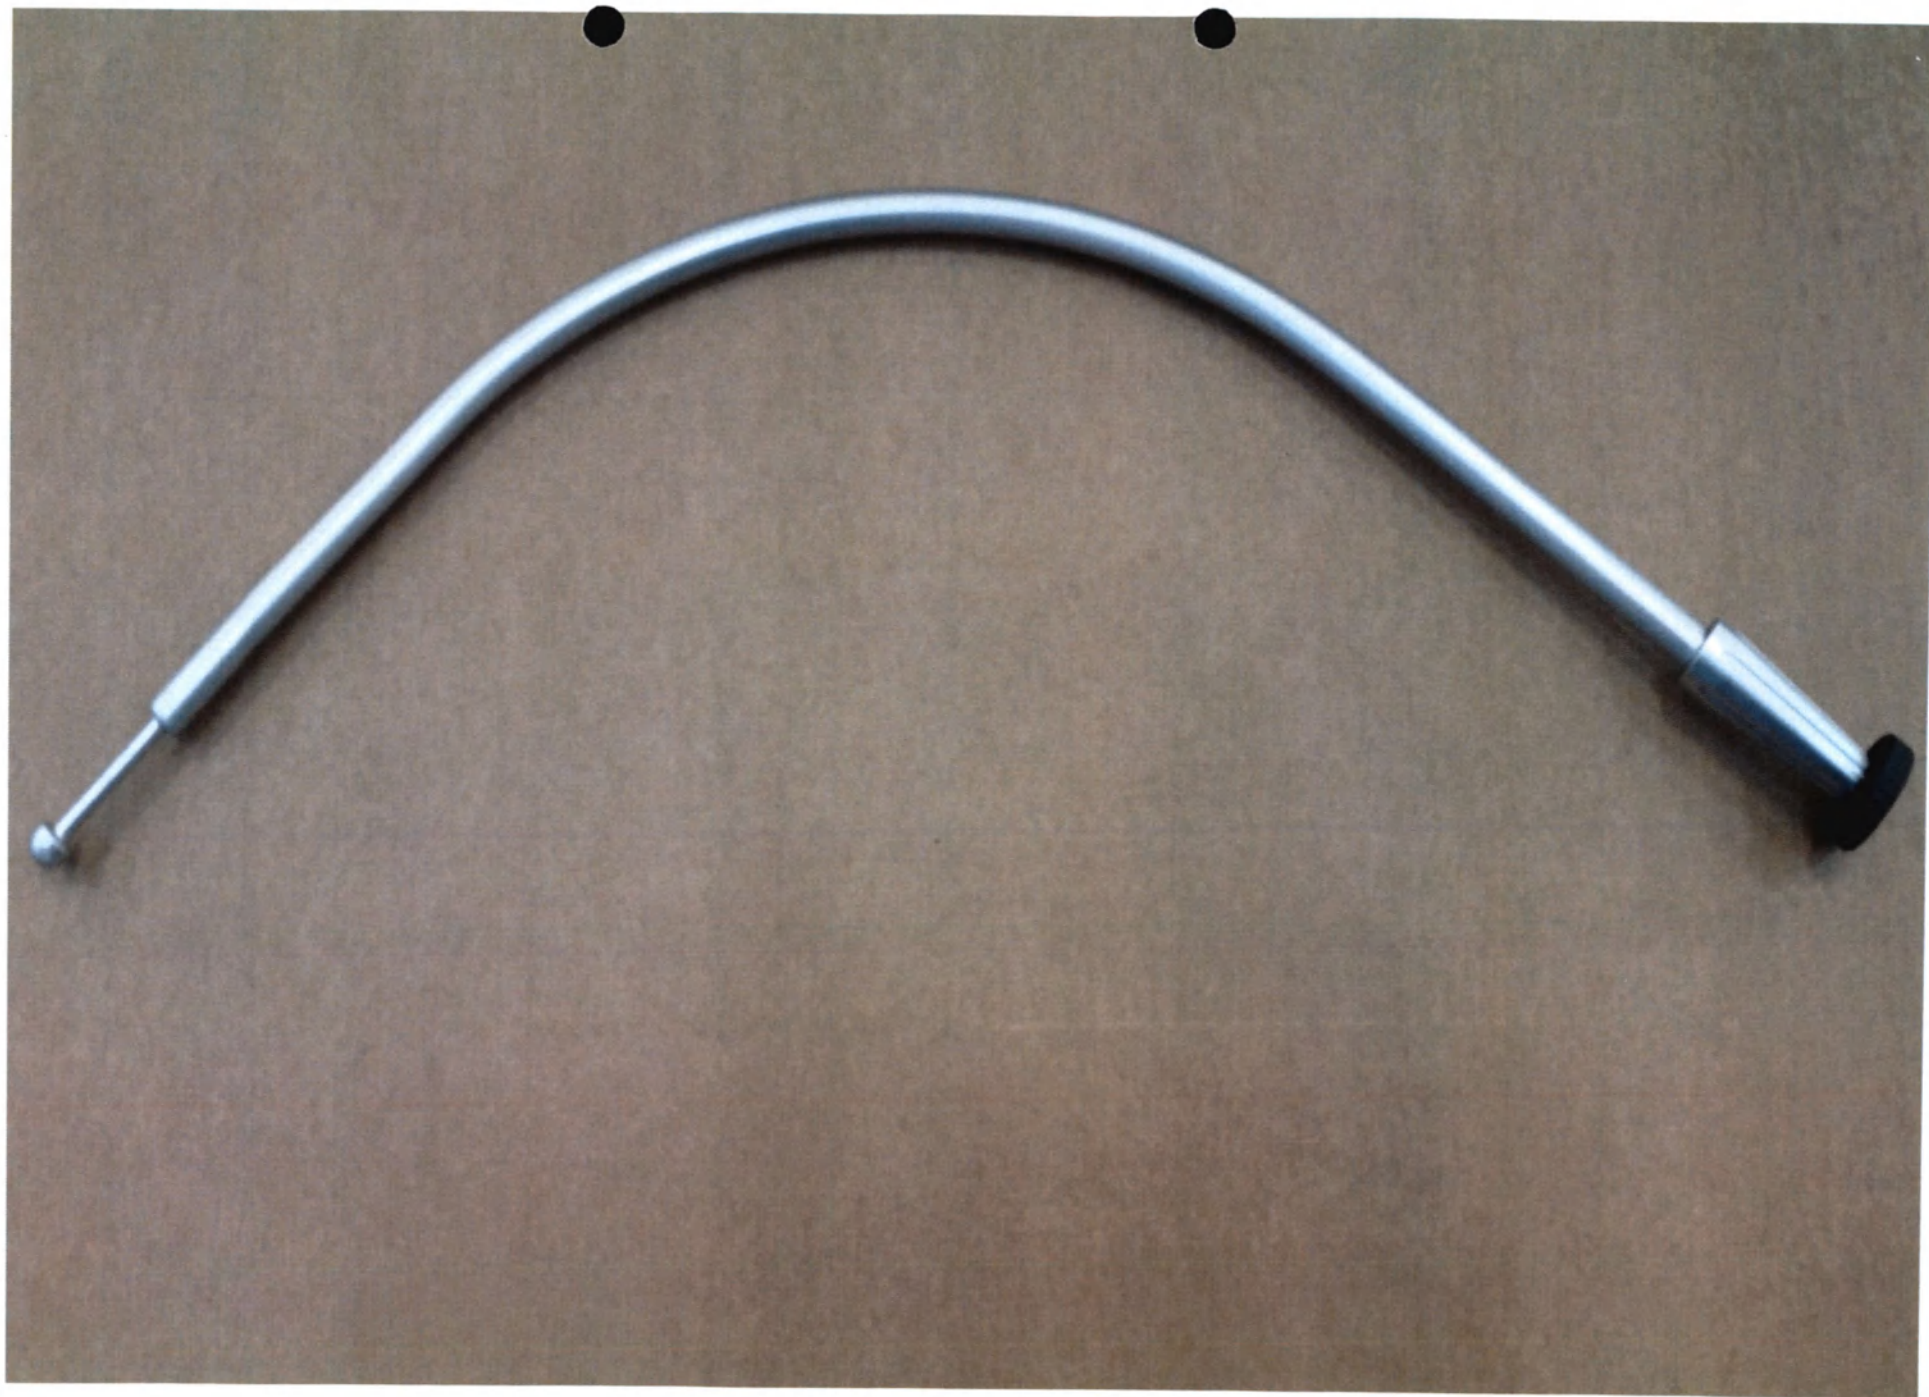


Кронштейн для гастростомии, в комплекте

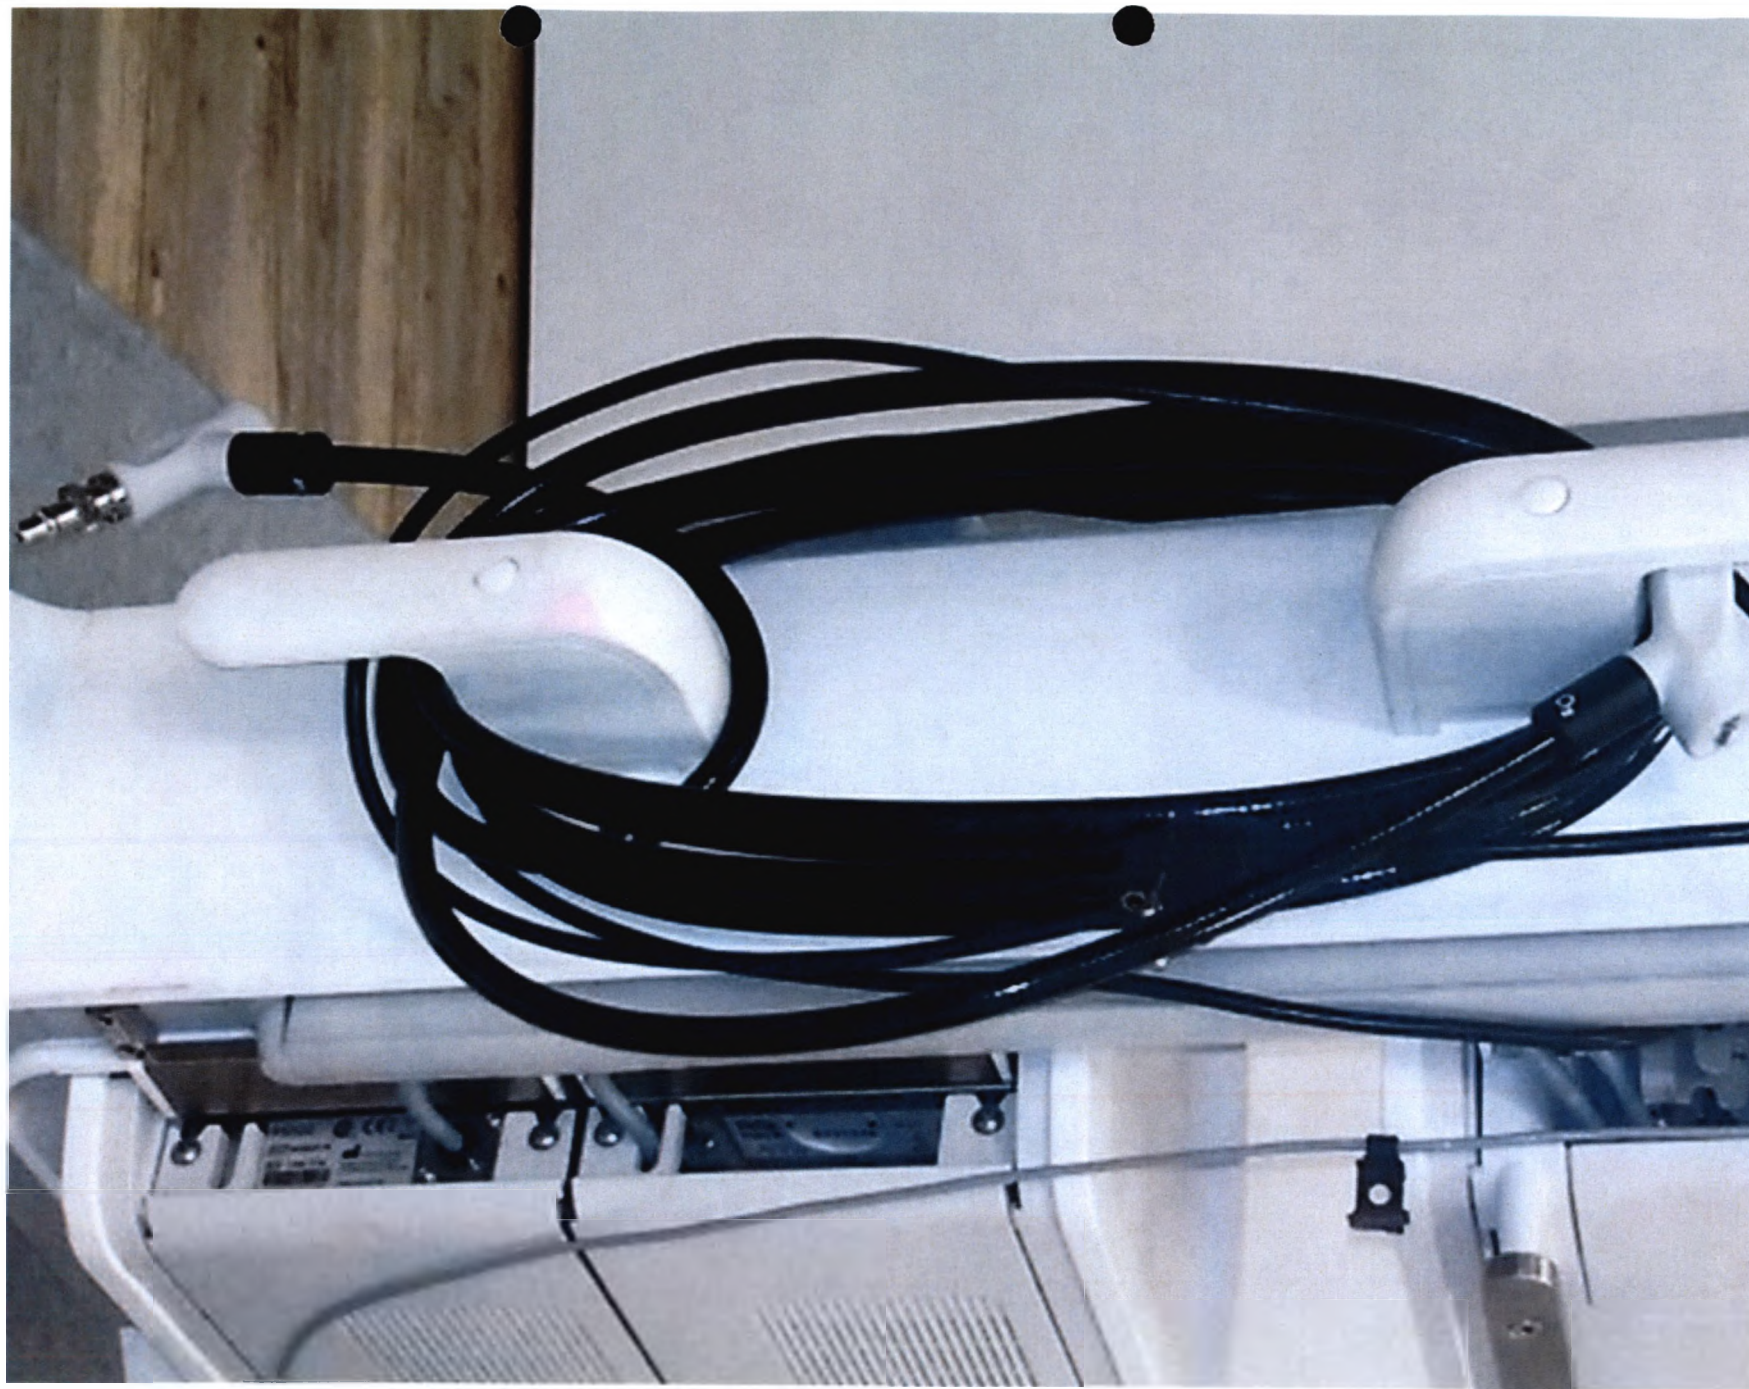

Шланги для центрального газоснабжения



Фильтр свежего воздуха

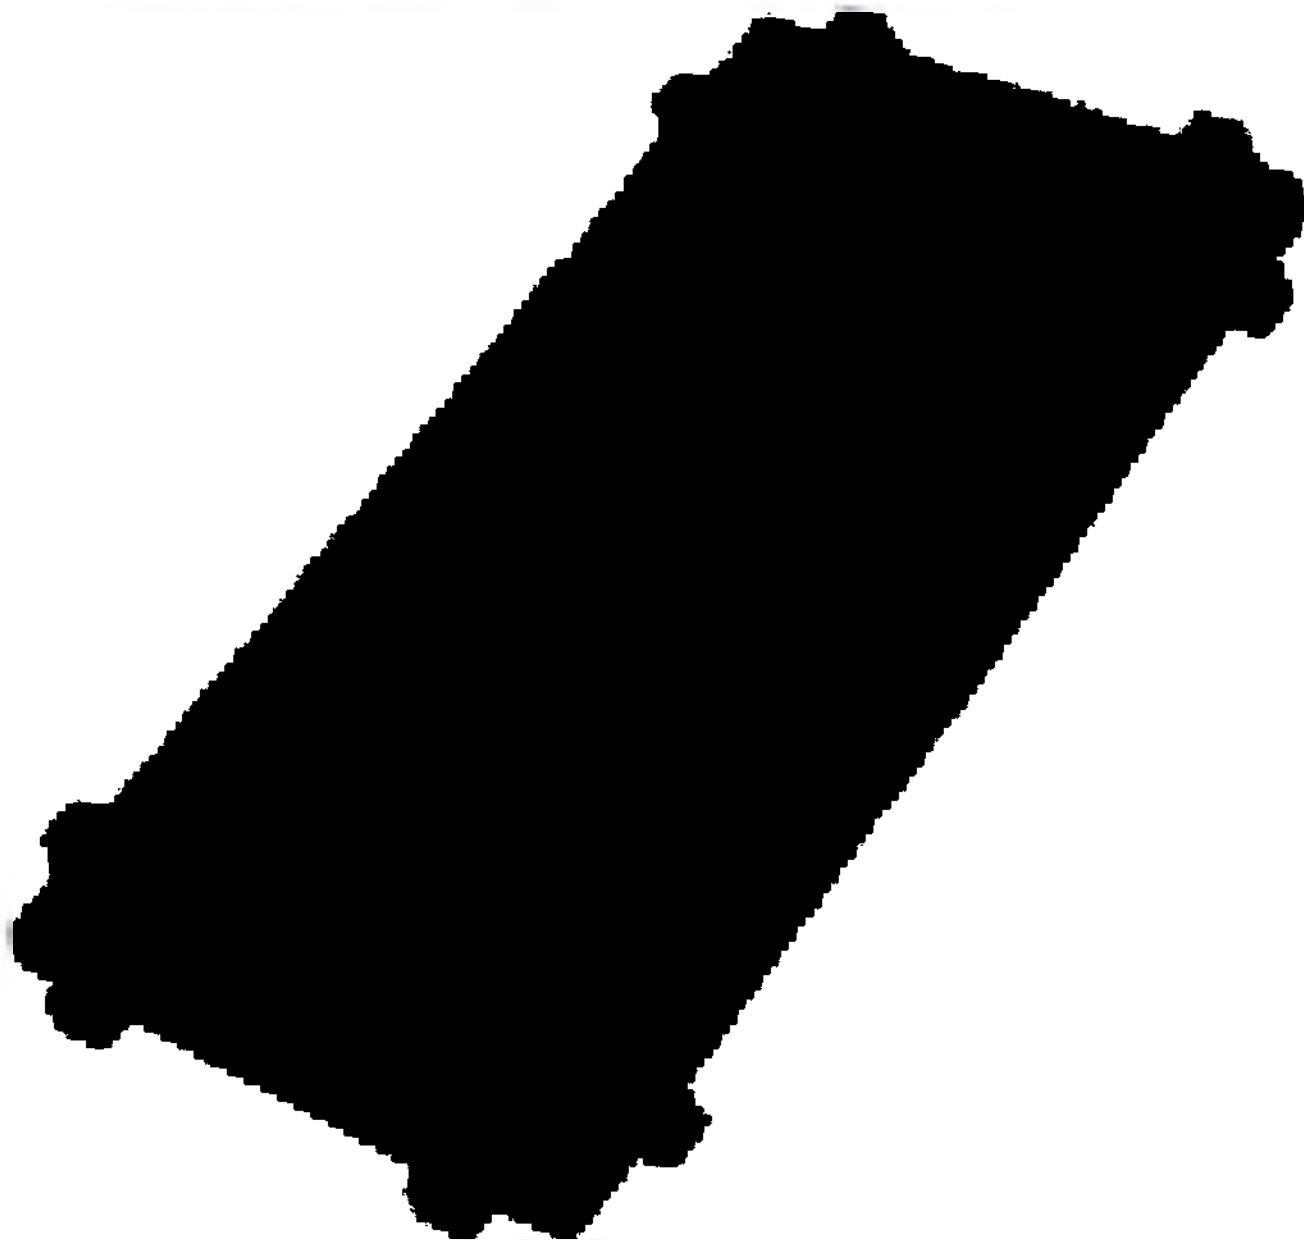

Воздушный фильтр



Набор трубок для подачи воды



Кабель для вызова медсестры

Всего пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью
43 листа (ов)

