


«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «НПФ «МЕДТЕХМАРКЕТ»

 Б.С. Хышиктуев

апреля 2022 г.



**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

**Насос инфузионный SN, варианты исполнения: SN-50C6, SN-50C66R, SN-50F6,
SN-50F66R, SN-50C6T, SN-50C66TR, SN-50T66, SN-50T66R,
SN-A1, SN-A2T**

1



2




Фотографическое изображение насоса шприцевого SN-50C6/SN-50C66R (1) и кабеля питания (2).



Фотографическое изображение маркировки насоса шприцевого SN-50C6 (тыльная сторона).

1

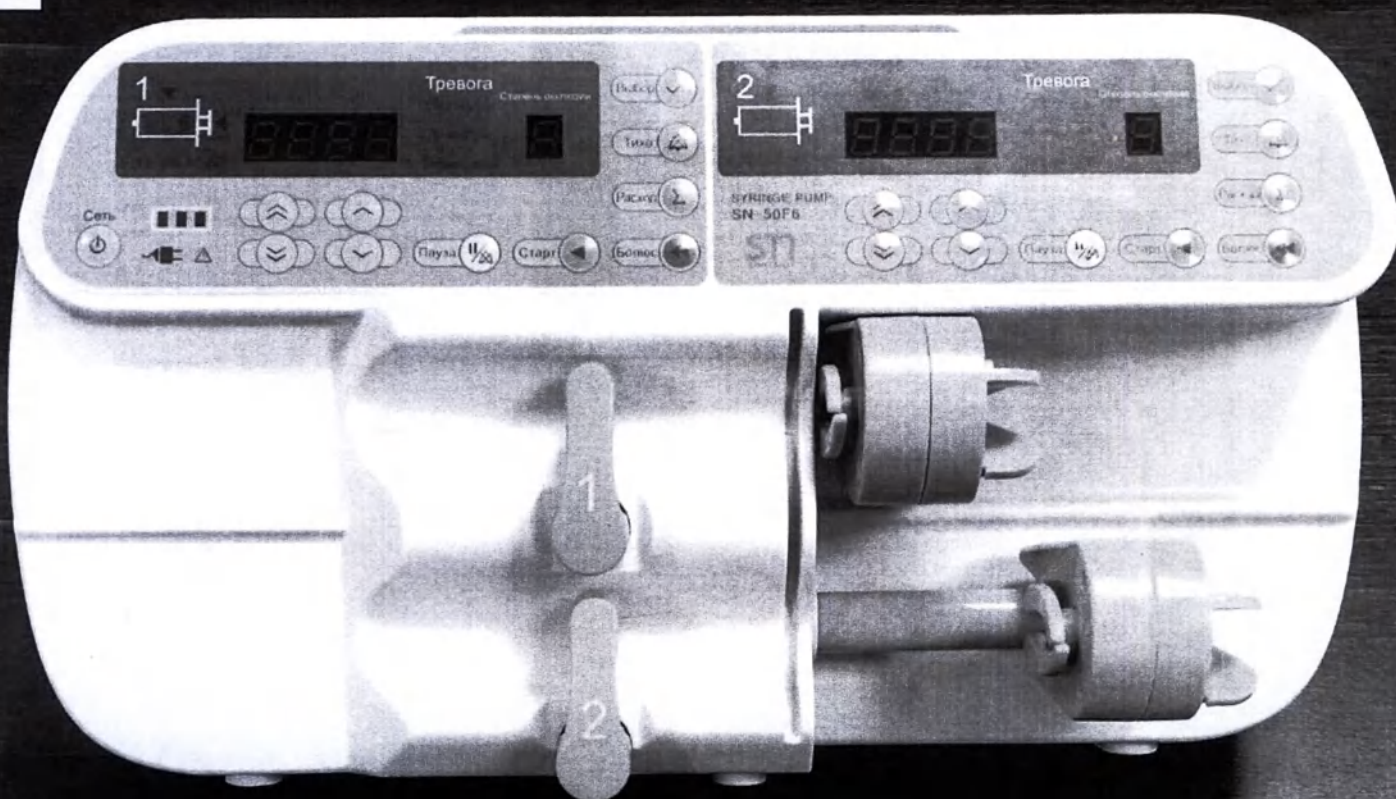

2



Фотографическое изображение насоса шприцевого SN-50F6/SN-50F66R (1) и кабеля питания (2).

1

SINO

无锡圣和医疗器械有限公司
Sino Medical-Device Technology Co., Ltd.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

«Насос шприцевой SN-50C66R»

2

无锡圣和医疗器械有限公司
Sino Medical-Device Technology Co., Ltd.

Упаковочный лист Насос шприцевой SN-50C66R

№	Наименование	Количество, шт.	Примечание
1	Основной блок со встроенной никель-металлогидридной батареей и креплением к стойке	1	
2	Кабель питания	1	
3	Руководство по эксплуатации	1	
4	Паспорт	1	
5	Гарантийный талон	1	
6	Упаковочный лист	1	

3

Паспорт изделия

Идентификация изделия

Модель	Насос шприцевой SN-50C66R
Серийный номер	
Дата выпуска	

Свидетельство о приеме

Изделие принято к эксплуатации

Дата приема:

Примечание:

Гарантия производителя

Берлингер промфармфакт — медицинская продукция

- Гарантия качества вступает в силу с даты выдачи изделия, подтвержденной печатью и подписью продавца в паспорте изделия. В период действия гарантийного срока производитель не несет ответственности за любые повреждения, возникшие в результате неправильной эксплуатации, некачественных материалов или некачественной сборки изделия.

Гарантия предусматривает бесплатный ремонт в течение всего гарантийного срока при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения, ухода и эксплуатации изделия.

- В случае устранения неисправности по гарантии, гарантийный срок продлевается на время нахождения изделия в ремонте.

4

SINO

Гарантийный талон

Отметка о продаже

Модель: Насос шприцевой SN-50C66R

Серийный номер:

Дата выпуска:

Подпись продавца:

Подпись покупателя:

Согласие об эксплуатации изделия:

Подпись покупателя:

Подпись продавца:

Срок действия: 36 месяцев

Срок действия: 36 месяцев

Срок действия: 36 месяцев

Срок действия: 36 месяцев

Срок действия: 36 месяцев

Срок действия: 36 месяцев

Срок действия: 36 месяцев

Срок действия: 36 месяцев

Срок действия: 36 месяцев

Срок действия: 36 месяцев

Срок действия: 36 месяцев

Срок действия: 36 месяцев

Срок действия: 36 месяцев

Срок действия: 36 месяцев

Срок действия: 36 месяцев

Срок действия: 36 месяцев

Срок действия: 36 месяцев

Срок действия: 36 месяцев

Срок действия: 36 месяцев

Срок действия: 36 месяцев

Срок действия: 36 месяцев

Срок действия: 36 месяцев

Срок действия: 36 месяцев

Срок действия: 36 месяцев

Срок действия: 36 месяцев

Срок действия: 36 месяцев

Срок действия: 36 месяцев

Срок действия: 36 месяцев

Срок действия: 36 месяцев

Срок действия: 36 месяцев

Срок действия: 36 месяцев

Срок действия: 36 месяцев

Срок действия: 36 месяцев

Срок действия: 36 месяцев

Срок действия: 36 месяцев

Срок действия: 36 месяцев

Срок действия: 36 месяцев

Срок действия: 36 месяцев

Срок действия: 36 месяцев

Срок действия: 36 месяцев

Срок действия: 36 месяцев

Срок действия: 36 месяцев

Срок действия: 36 месяцев

Срок действия: 36 месяцев

Срок действия: 36 месяцев

Срок действия: 36 месяцев

Срок действия: 36 месяцев


Срок действия: 36 месяцев

Срок действия: 36 месяцев

1



2

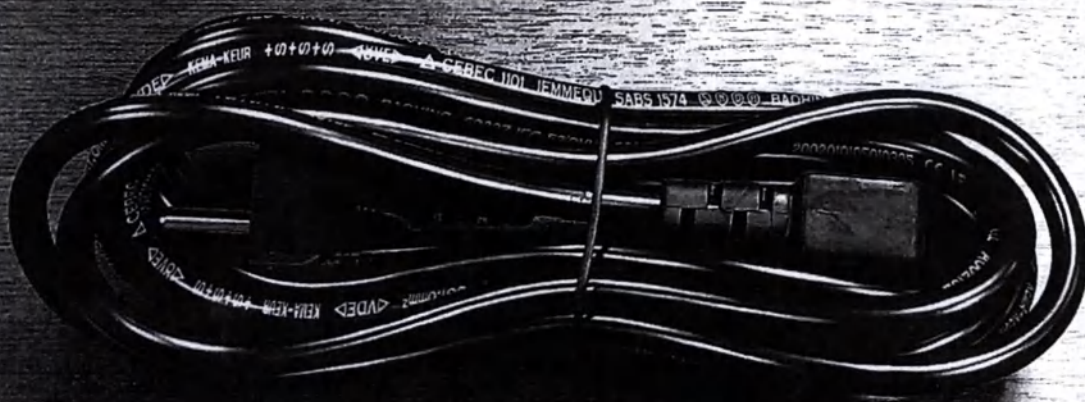

Фотографическое изображение насоса шприцевого SN-50C6T/SN-50C66TR (1) и кабеля питания (2).



Фотографическое изображение маркировки насоса шприцевого SN-50C66TR (тыльная сторона).

1

SHINO MEDICAL-DEVICE TECHNOLOGY CO., LTD.
Sino Medical-Device Technology Co., Ltd.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

«Насос шприцевой SN-50C66R»

2

SHINO MEDICAL-DEVICE TECHNOLOGY CO., LTD.
Sino Medical-Device Technology Co., Ltd.

Упаковочный лист Насос шприцевой SN-50C66R

№	Наименование	Количество, шт.	Примечание
1	Основной блок с встроенной помпой и батареей в крепящем к слове	1	
2	Кабель питания	1	
3	Руководство по эксплуатации	1	
4	Паспорт	1	
5	Гарантийный талон	1	
6	Упаковочный лист	1	

3

Паспорт изделия

Идентификация изделия

Модель	Насос шприцевой SN-50C66R
Серийный номер	
Оформлен в	
Дата выпуска	

Свидетельство о приеме

Изделие получено по документам

Дата приема

Подпись

Гарантия производителя

Гарантия производителя _____ месяцев со дня продажи.

- Гарантия производителя действует в случае продажи изделия с установленными широтами и подлинными документами в паспорте изделия. В противном случае гарантия производителя не действует. Обладатель изделия обязан соблюдать правила эксплуатации, указанные в руководстве по эксплуатации. В случае нарушения правил эксплуатации, повреждения изделия или некачественной сборки изделия.

Гарантия производителя действует только в случае, если изделие было приобретено у официального дилера производителя. В противном случае гарантия производителя не действует.

- В случае утери или повреждения документа, подтверждающего право собственности на изделие, владелец должен обратиться к производителю для получения копии документа.

4

Гарантийный талон

Отчет о продаже

Модель: Насос шприцевой SN-50C66R

Серийный номер

Получатель: _____

Дата: _____

Подпись: _____

Сделано в _____

Подпись: _____

Подпись: _____

Подпись: _____

Подпись: _____

Подпись: _____

Подпись: _____

Подпись: _____

Подпись: _____

Подпись: _____

Подпись: _____

Подпись: _____

Подпись: _____

Подпись: _____

Подпись: _____

Подпись: _____

Подпись: _____

Подпись: _____

Подпись: _____

Подпись: _____

Подпись: _____

Подпись: _____

Подпись: _____

Подпись: _____

Подпись: _____

Подпись: _____

Подпись: _____

Подпись: _____

Подпись: _____

Подпись: _____

Подпись: _____

Подпись: _____

Подпись: _____

Подпись: _____

Подпись: _____

Подпись: _____

Подпись: _____

Подпись: _____

Подпись: _____


Подпись: _____

Подпись: _____

Подпись: _____

Подпись: _____





Подпись: _____

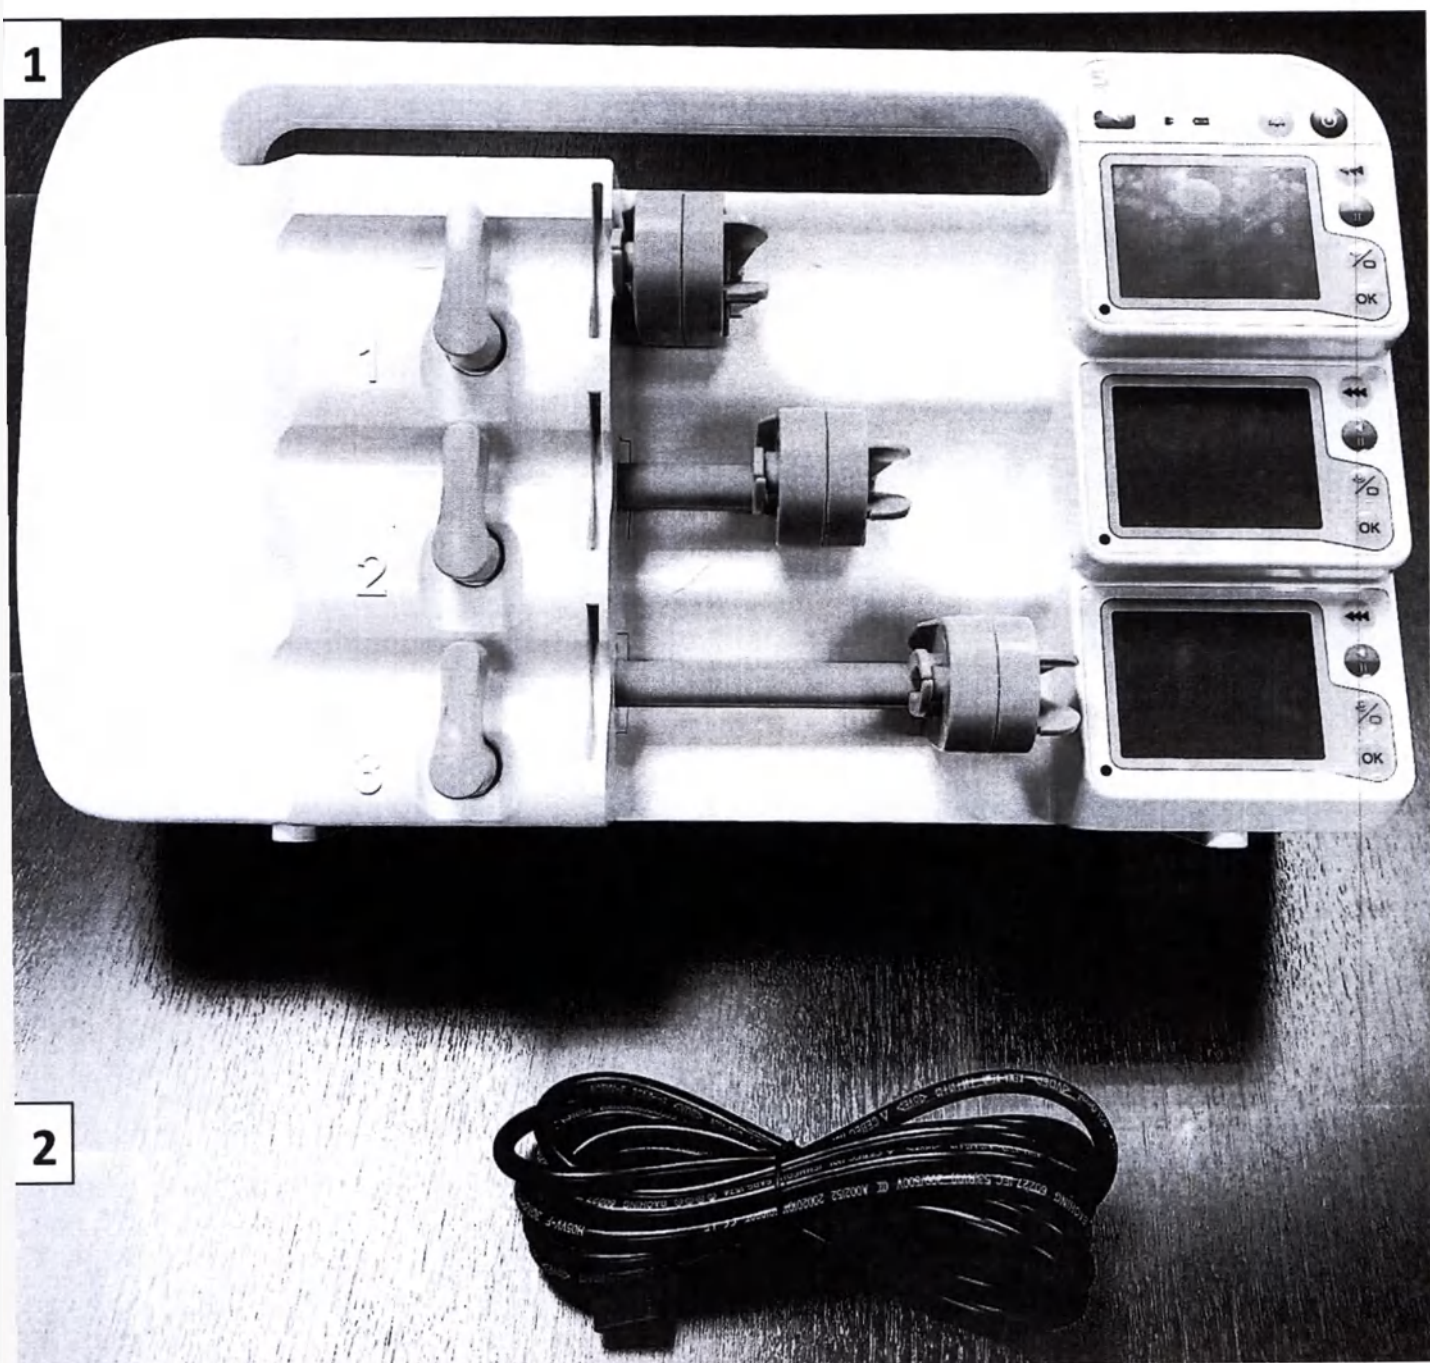

Фотографическое изображение насоса шприцевого SN-50T66/SN-50T66R (1) и кабеля питания (2).



Фотографическое изображение маркировки насоса шприцевого SN-50T66R (тыльная сторона).

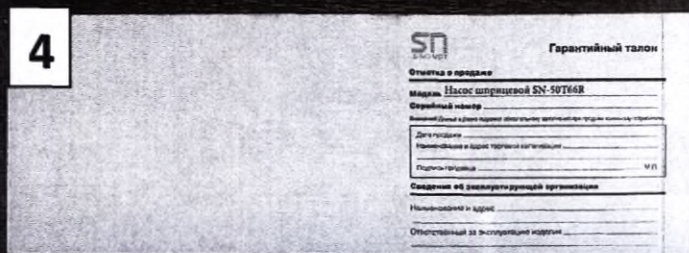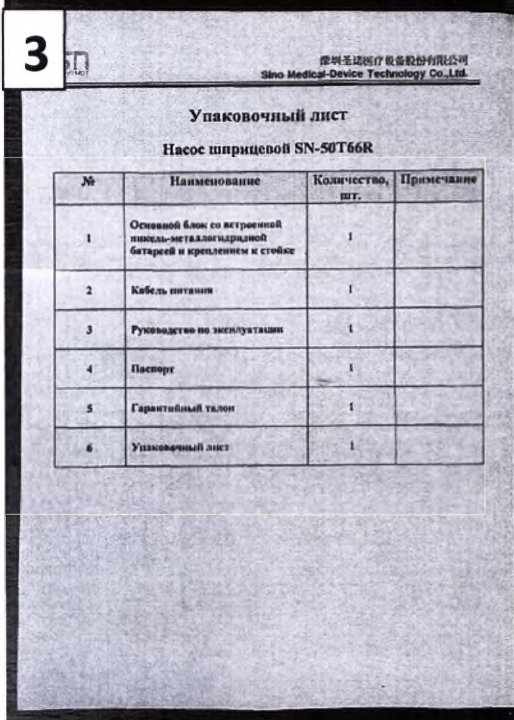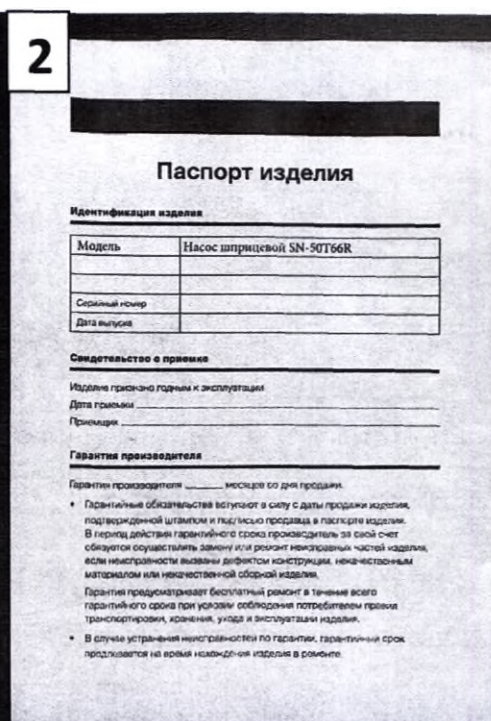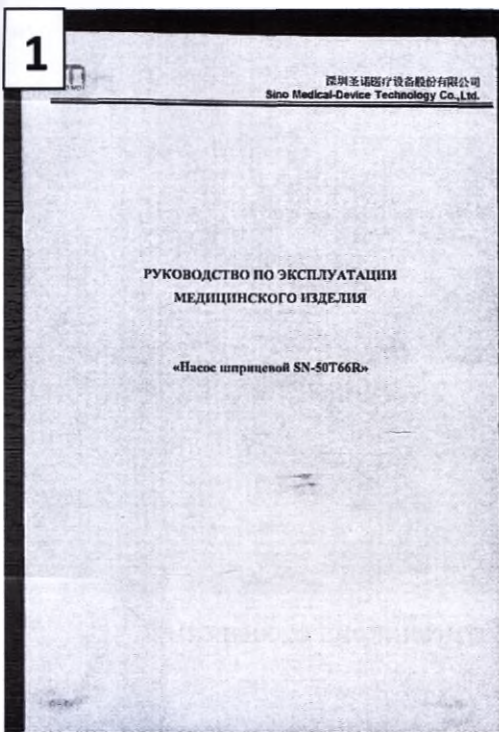


Фотографическое изображение руководства по эксплуатации (1), паспорта (2), упаковочного листа (3) и гарантийного талона (4) для насоса шприцевого SN-50T66/SN-50T66R.

1

2

Фото насоса шприцевого SN-A1/SN-A2T (1) и адаптера сетевого питания (2).

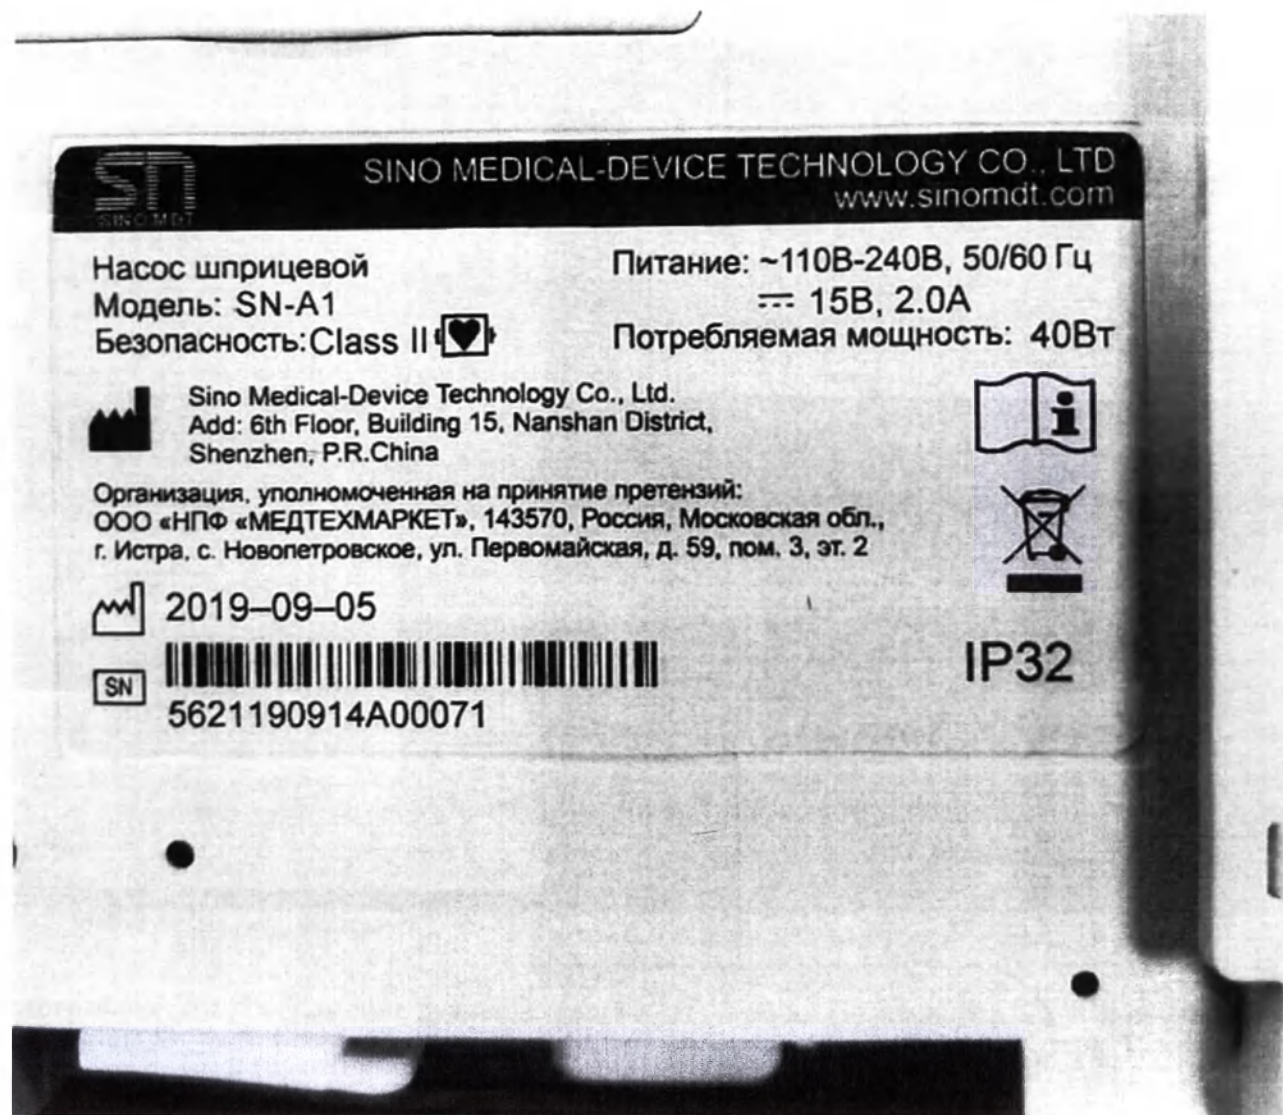

Фотографическое изображение маркировки насоса шприцевого SN-A1 (нижняя сторона).

1

深圳美诺医疗设备有限公司
Sino Medical-Device Technology Co., Ltd.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

«Насос шприцевой SN-A2T»

2

Паспорт изделия

Идентификация изделия

Модель	Насос шприцевой SN-A2T
Серийный номер	
Дата выпуска	

Свидетельство о приеме

Идентификационный номер изделия

Дата приема

Подпись

Гарантия производителя

Гарантия производителя _____ месяцев со дня выпуска

- Гарантия производителя распространяется на изделия, изготовленные из высококачественных материалов и прошедшие строгий контроль качества. В период действия гарантии производитель несет ответственность за ремонт или замену изделия, если выявлены дефекты, вызванные производством. Исключаются изделия, поврежденные в результате неправильного использования, хранения, транспортировки или воздействия внешних факторов.
- Гарантия производителя не распространяется на изделия, которые были модифицированы, отремонтированы или использовались не по назначению. В случае возникновения претензий к качеству изделия, пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом обслуживания клиентов.

3

深圳美诺医疗设备有限公司
Sino Medical-Device Technology Co., Ltd.

Упаковочный лист Насос шприцевой SN-A2T

№	Наименование	Количество, шт.	Примечание
1	Описание насоса с подробным описанием (3000 шт.)	1	
2	Лист гарантийного обязательства	1	
3	Руководство по эксплуатации	1	
4	Гарантийный талон	1	
5	Упаковочный лист	1	
6	Набор инструментов для ремонта (300 шт.)	1	г. 2018 г. 10 мес
7	Крепежные элементы	1	г. 2018 г. 10 мес
8	Винты для крепления элементов	1	г. 2018 г. 10 мес
9	Набор инструментов (300 шт.)	1	г. 2018 г. 10 мес
10	Руководство по эксплуатации	1	г. 2018 г. 10 мес

4

Гарантийный талон

Отметка о приеме

Модель: Насос шприцевой SN-A2T

Серийный номер

Идентификационный номер изделия

Дата выпуска

Подпись

Согласие об эксплуатации организации

Идентификационный номер

Одобрение организации

Одобрение организации

Одобрение организации

Одобрение организации

Одобрение организации

Одобрение организации

Одобрение организации

Одобрение организации

Одобрение организации

Одобрение организации

Одобрение организации

Одобрение организации

Одобрение организации

Одобрение организации

Одобрение организации

Одобрение организации

Одобрение организации

Одобрение организации

Одобрение организации

Одобрение организации

Одобрение организации

Одобрение организации

Одобрение организации

Одобрение организации

Одобрение организации

Одобрение организации

Одобрение организации

Одобрение организации

Одобрение организации

Одобрение организации

Одобрение организации

Одобрение организации

Одобрение организации

Одобрение организации

Одобрение организации

Одобрение организации

Одобрение организации

Одобрение организации

Одобрение организации

Одобрение организации

Одобрение организации

Одобрение организации

Одобрение организации

Одобрение организации

Одобрение организации

Одобрение организации

Одобрение организации

Одобрение организации

Одобрение организации

Одобрение организации


Одобрение организации

Одобрение организации


Фотографическое изображение руководства по эксплуатации (1), паспорта (2), упаковочного листа (3) и гарантийного талона (4) для насоса шприцевого SN-A1/SN-A2T.




Фотографическое изображение переходника для коммуникационного порта для насоса шприцевого SN-A1/SN-A2T.

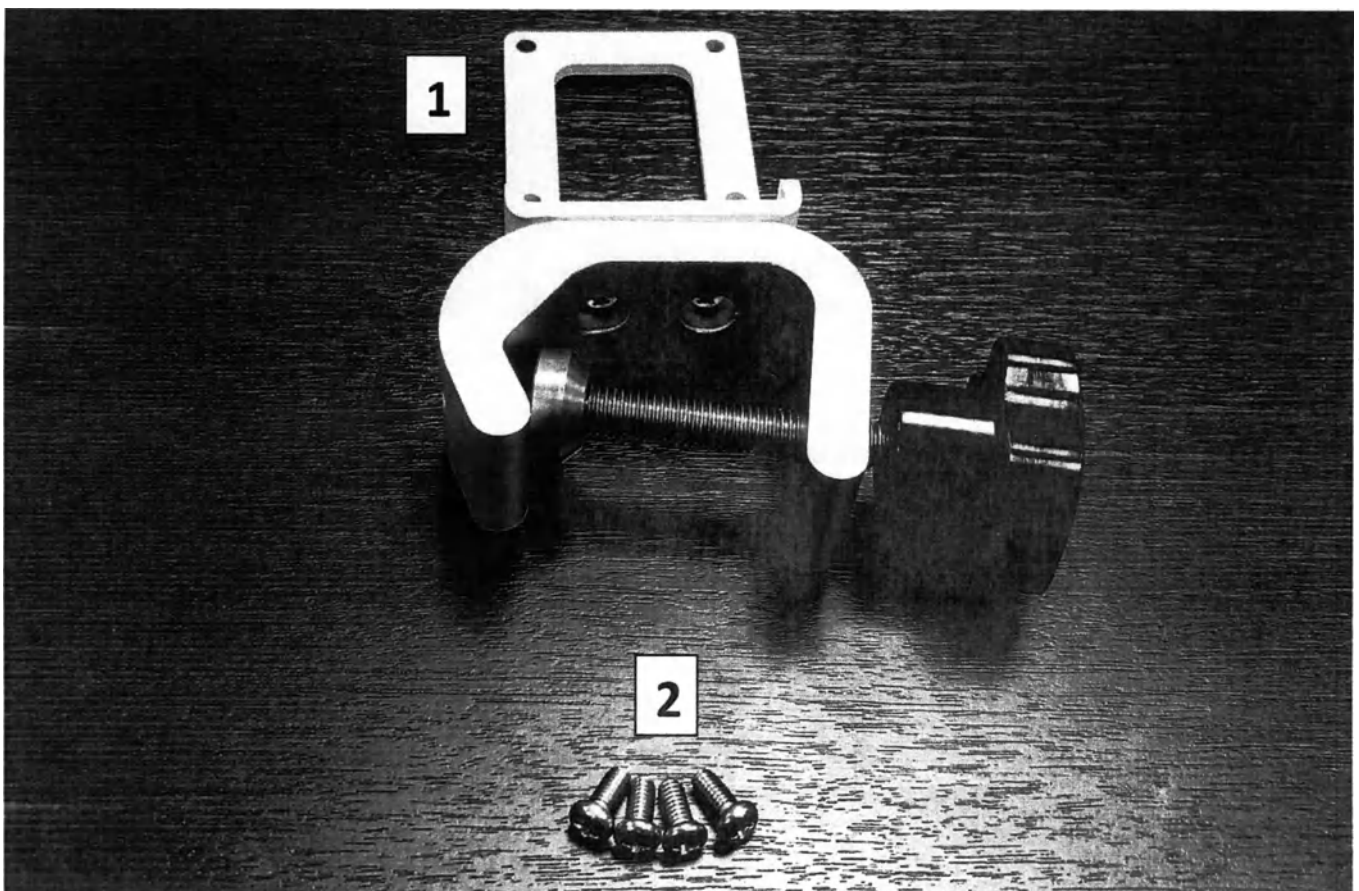



Фотографическое изображение крепления к стойке (1) и винтов для крепления к стойке (2) для насоса шприцевого SN-A1/SN-A2T.

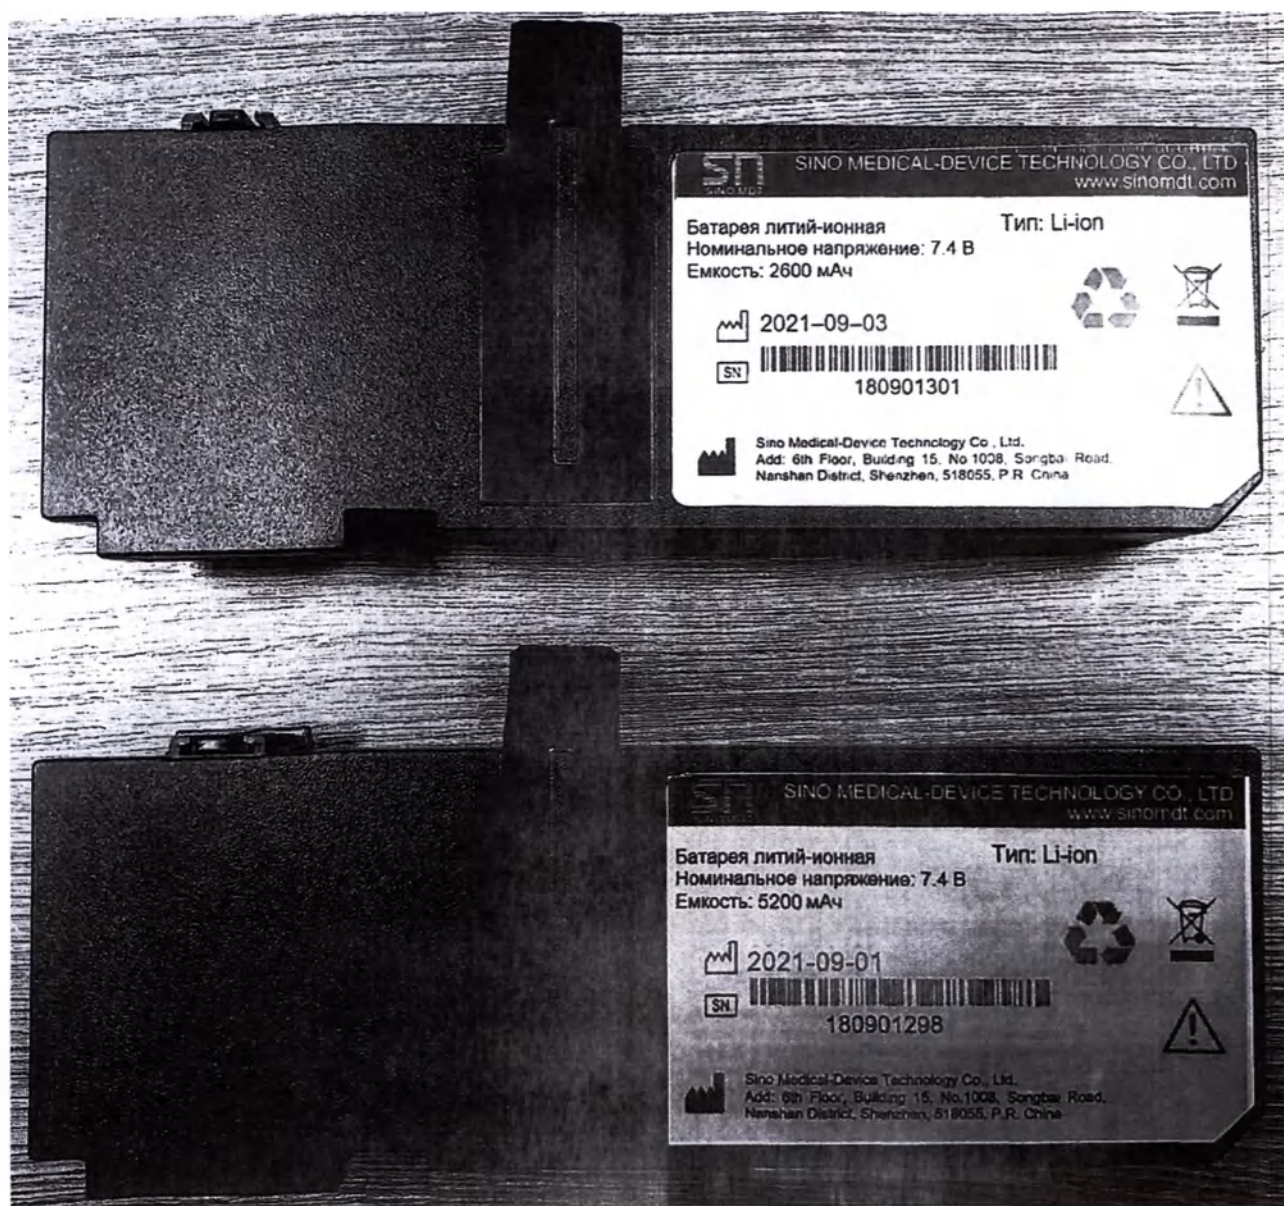



Фотографическое изображение батареи литий-ионной (2600 и 5200 мА*ч) для насоса шприцевого SN-A1/SN-A2T.

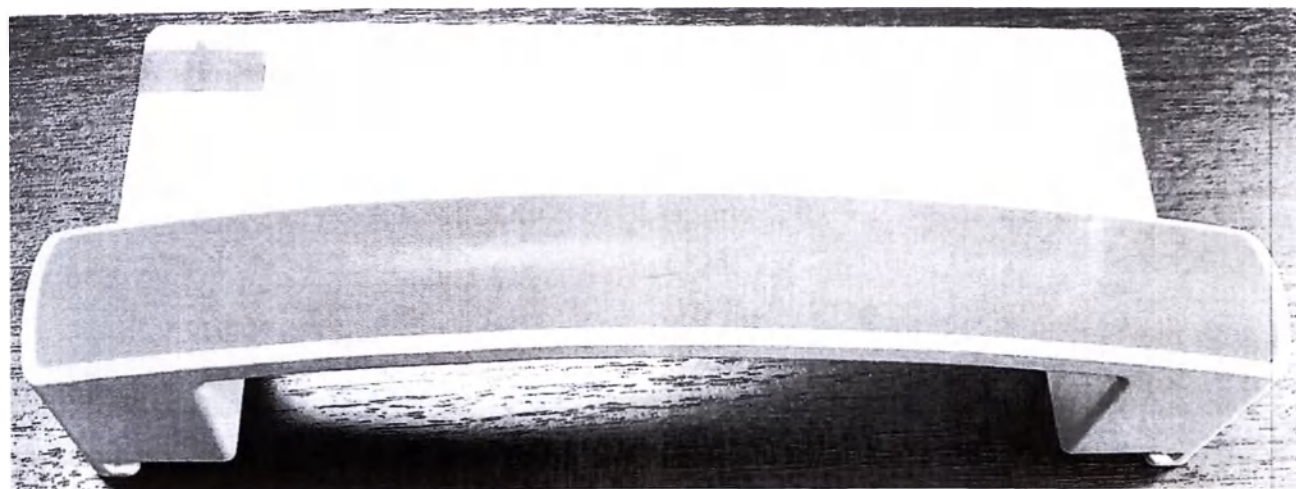



Фотографическое изображение ручки для переноски для насоса шприцевого SN-A1/SN-A2T.

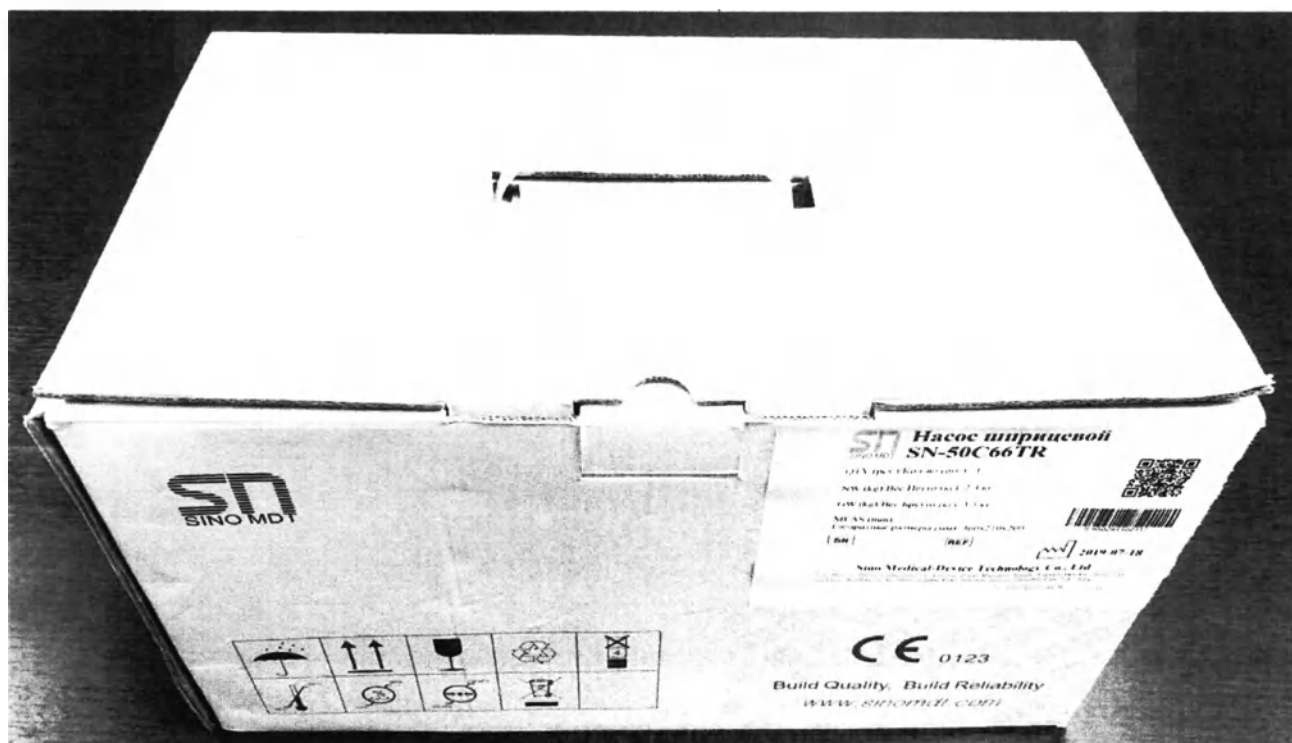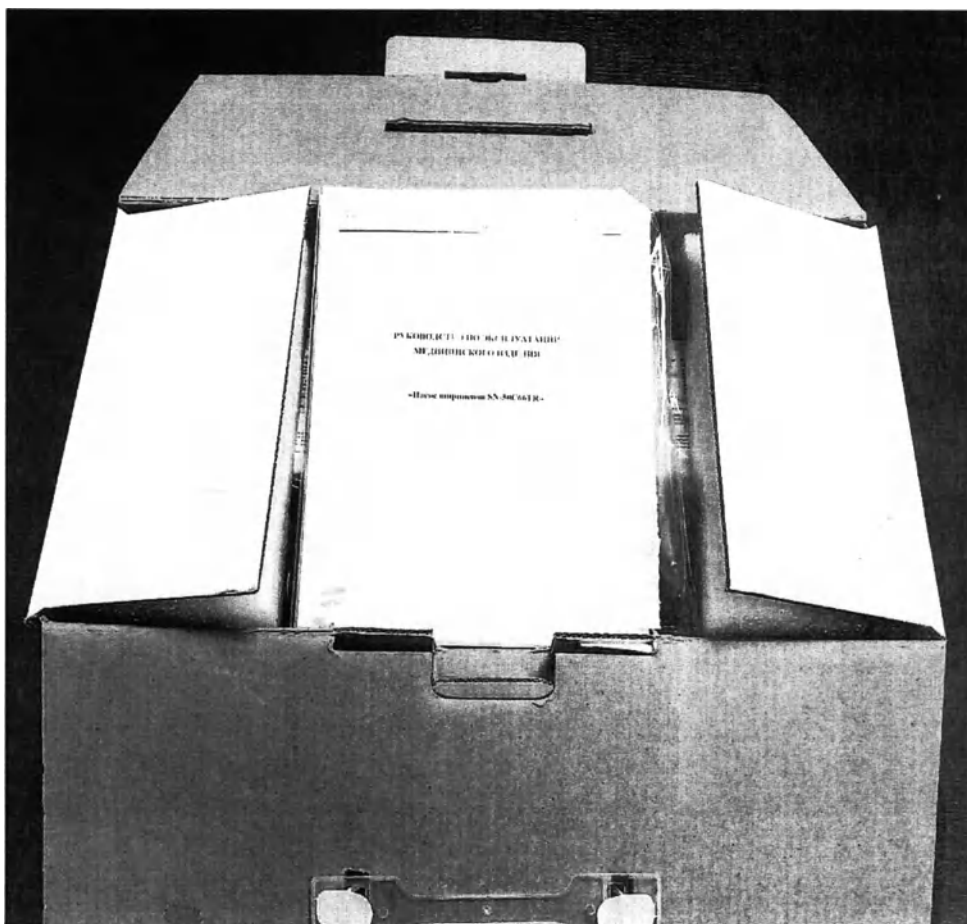

Фотографические изображения транспортной упаковки для насоса шприцевого SN-50C6T/SN-50C66TR.

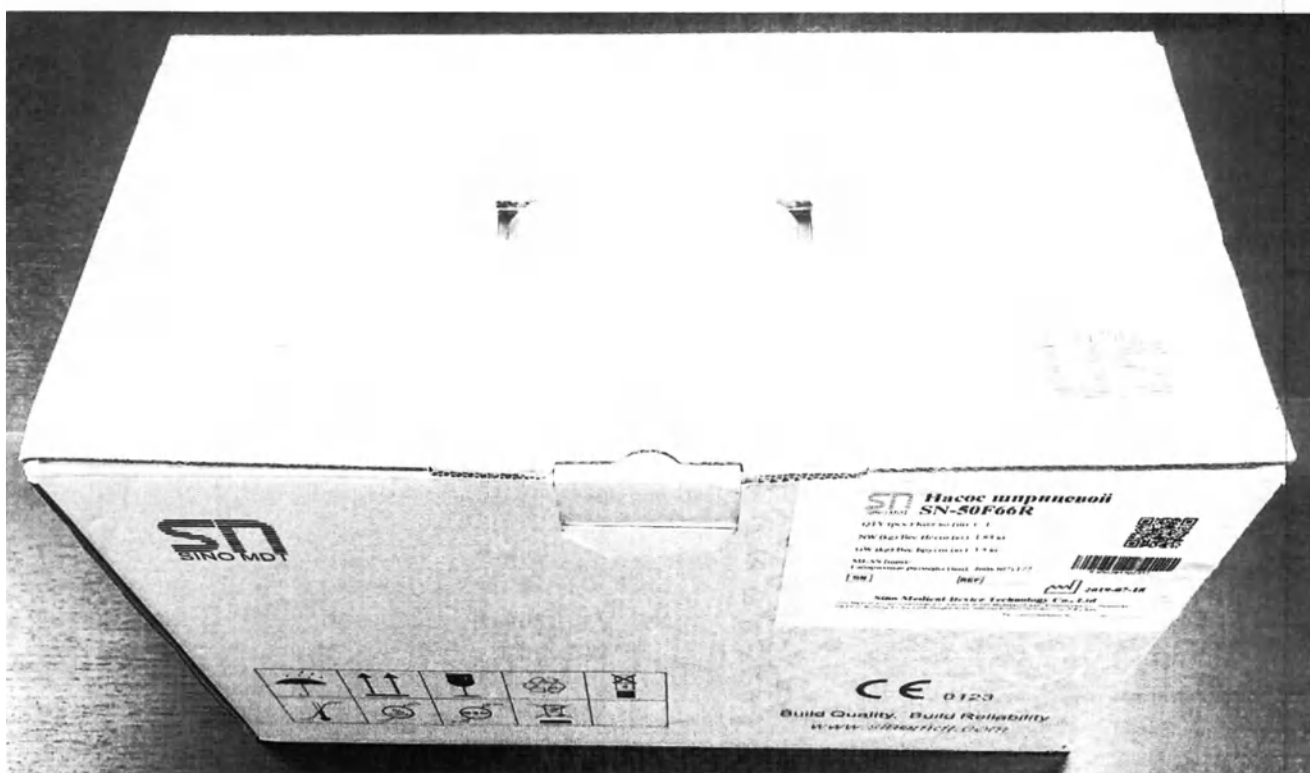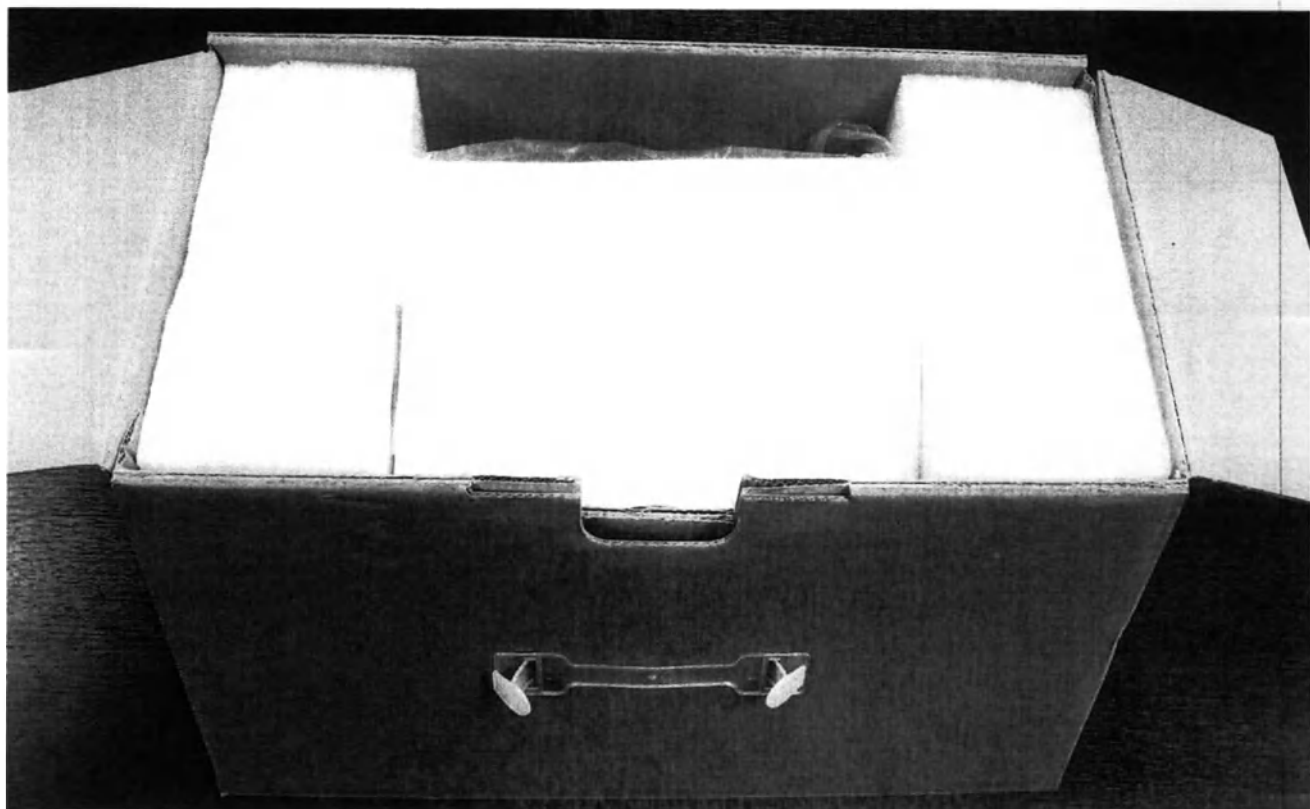

Фотографические изображения транспортной упаковки для насоса шприцевого SN-50F6/SN-50F66R.

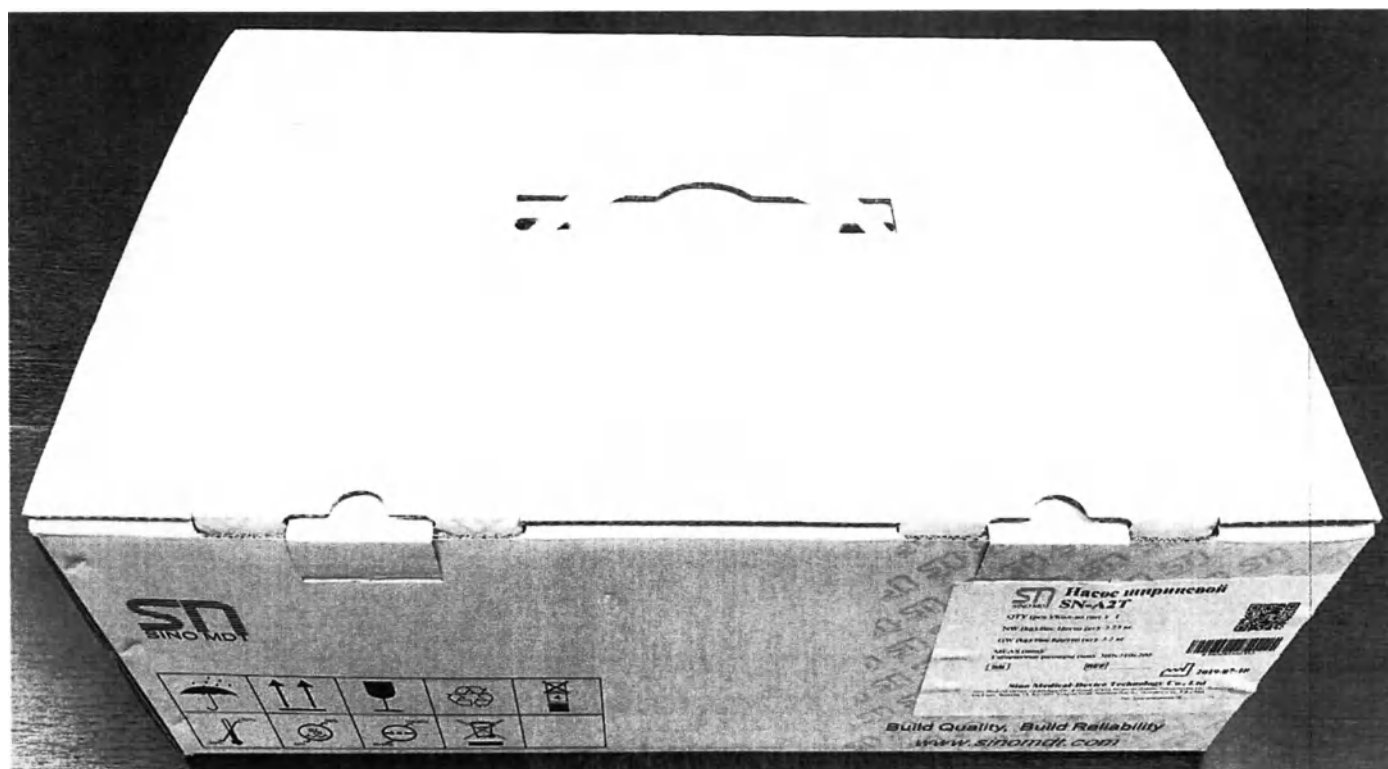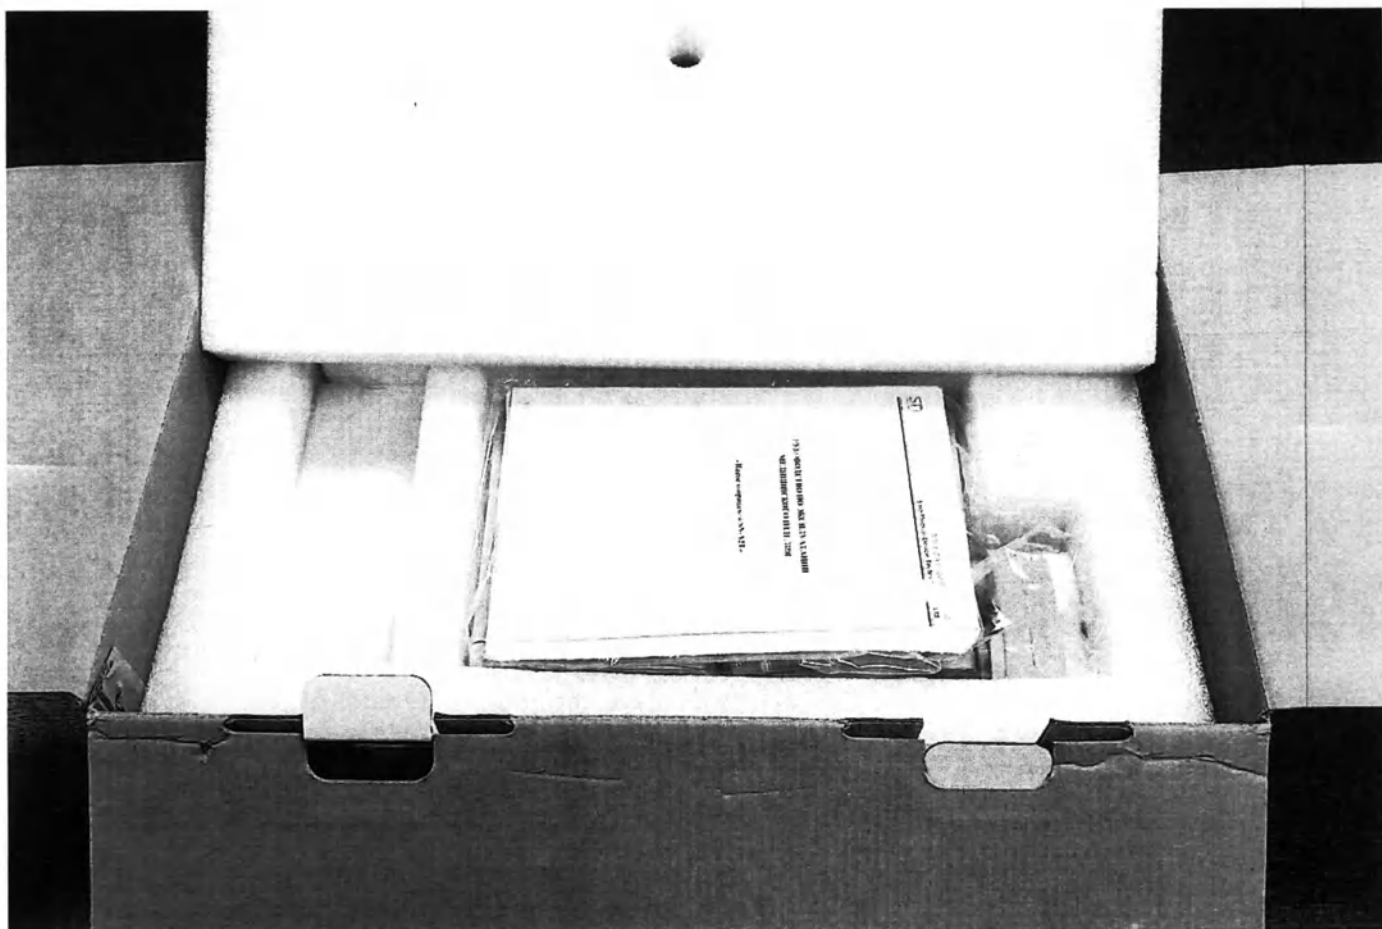

Фотографические изображения транспортной упаковки для насоса шприцевого SN-A1/SN-A2T.



Фотографические изображения транспортной упаковки для насоса шприцевого SN-50T66/SN-50T66R.

Генеральный директор ООО
«НПО «МЕДТЕХМАРКЕТ»
Б.С. Хышиктуев

