



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ХЭЛС МЕДИКАЛ ГРУПП»

Российская Федерация, 214012, г. Смоленск, ул. Кашена, д.1, оф. 706
+7 495 2043552 , post@healthmedical.ru , www.healthmedical.ru
ИНН 6732039529

Директор ООО "Хэлс Медикал Групп"


Татьянок В.В.



(Подпись)

2022 г.

Фотографические изображения медицинского изделия:
«Устройства одноразовые для переливания крови, инфузионных растворов, с принадлежностями»

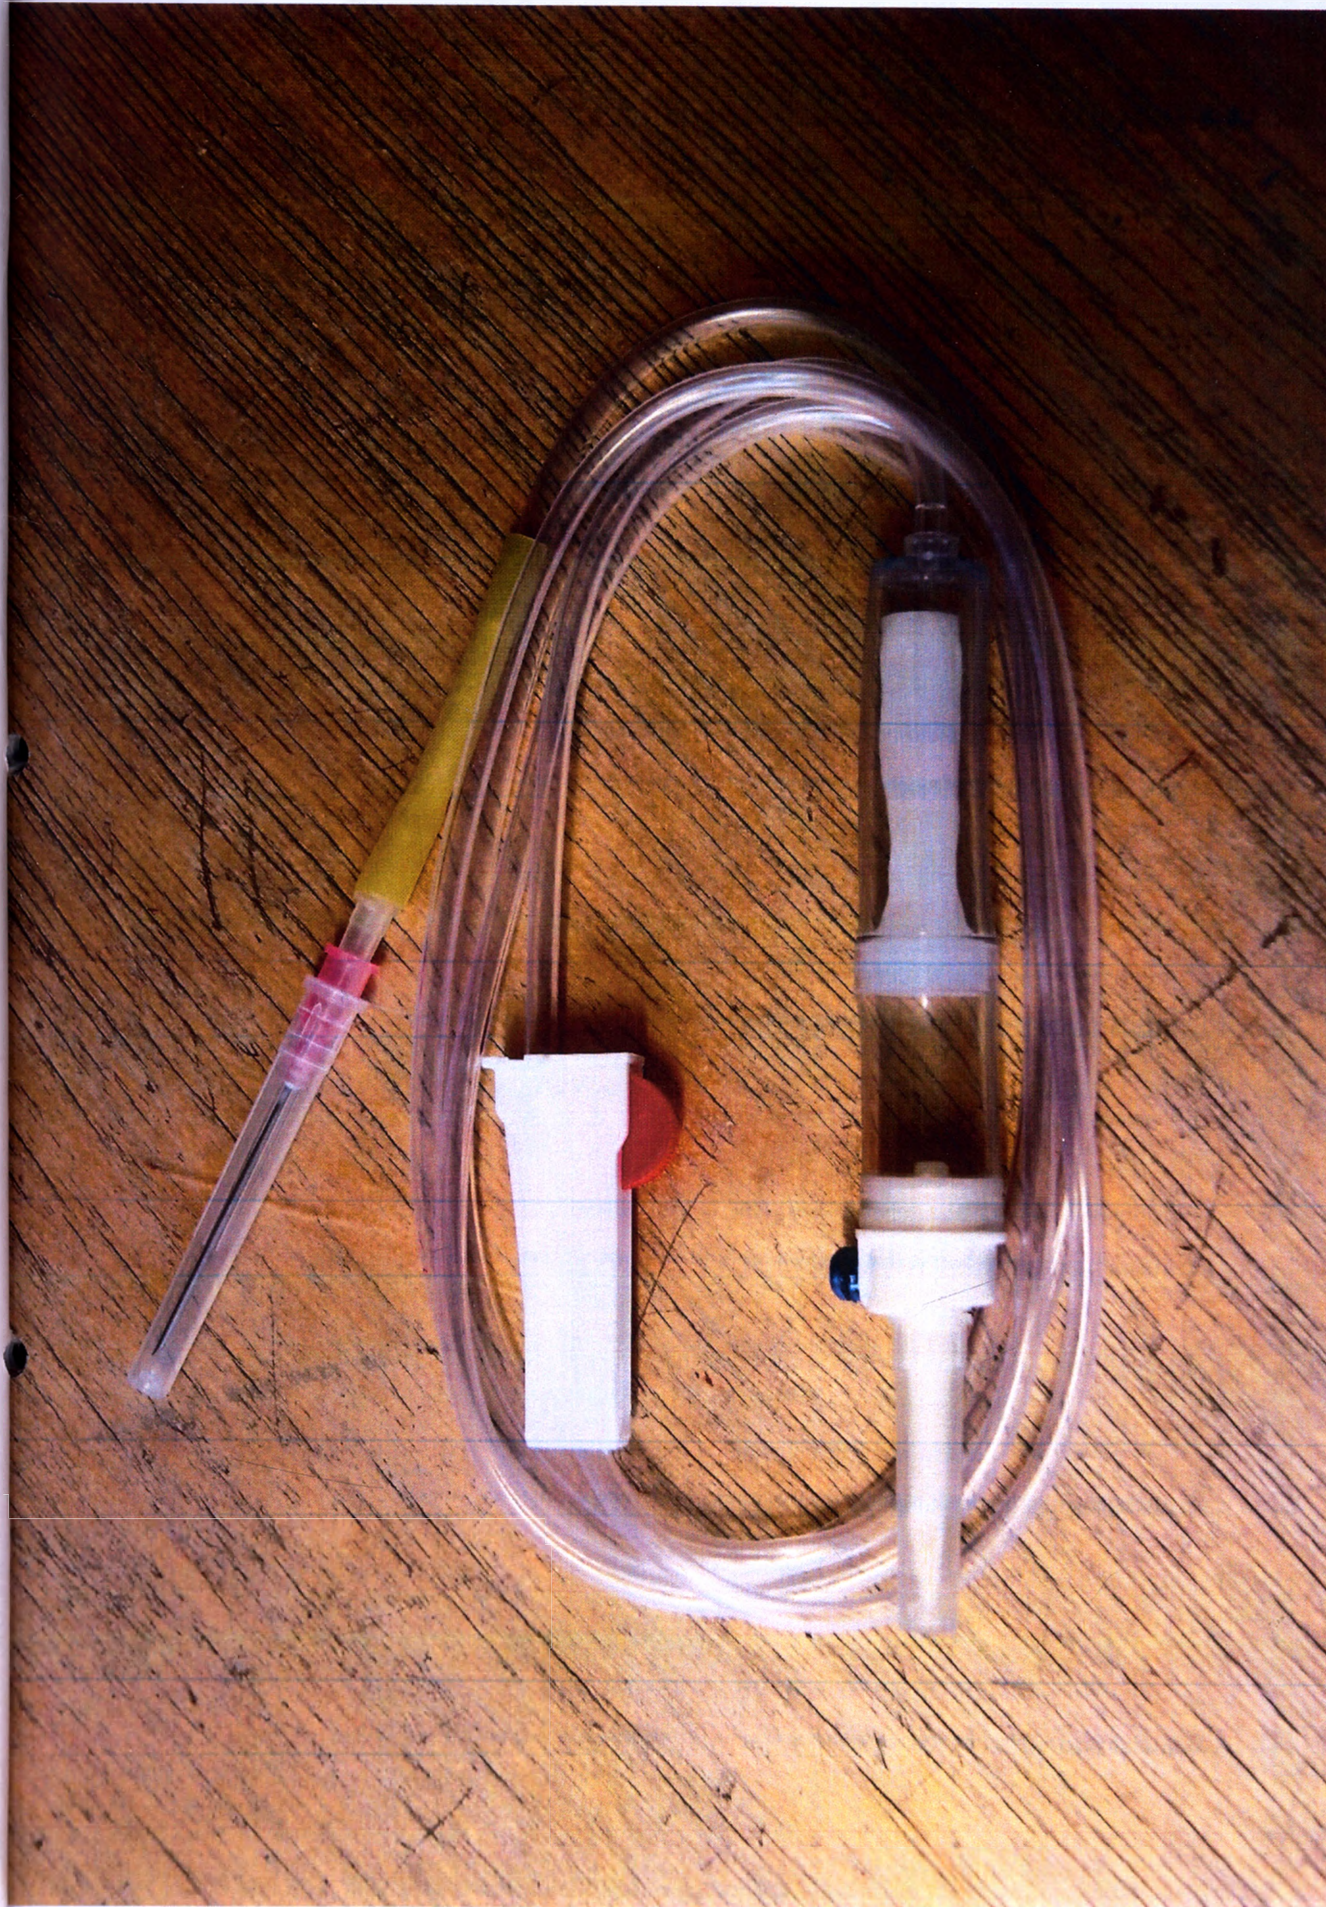

I. Устройство для переливания крови



1. Устройство переливания крови (в упаковке)

ОТКРЫВАТЬ ЗДЕСЬ

CE Angeltouch

2460

Устройство переливания для переливания крови, инфузионная система, с маркировкой

(см. Приложение на 1 листе)

Устройство для переливания крови
ру № ФСЗ 201212179 от ДД ММ ГГГГ



Устройство для переливания крови
НЕ ТОКСИЧНО, АПИРОГЕННО, СТЕРИЛИЗОВАНО
ЭТИЛЕНОКСИДОМ, ГАРАНТИЯ СТЕРИЛЬНОСТИ, ЕСЛИ
УПАКОВКА НЕ ПОВРЕЖДЕНА.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Проверьте целостность упаковки и наличие информации.
2. Проверьте целостность упаковки и наличие информации.
3. Установите устройство для переливания крови в вертикальном положении.
4. Подключите емкость. Наполните емкость в вертикальном положении.
5. Проверьте целостность упаковки и наличие информации.
6. Проверьте целостность упаковки и наличие информации.
7. Проверьте целостность упаковки и наличие информации.


ВНИМАНИЕ

- Не использовать, если упаковка открыта.
- Проверьте целостность упаковки и наличие информации.
- Проверьте целостность упаковки и наличие информации.
- Проверьте целостность упаковки и наличие информации.
- Проверьте целостность упаковки и наличие информации.

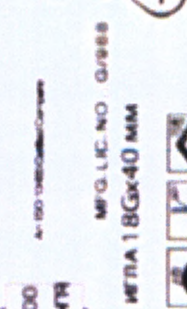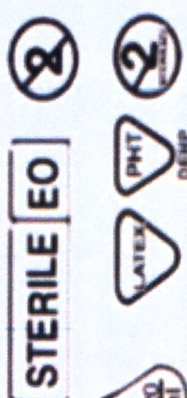


ANGIPLAST
Private limited
Plot 4803, Phase IV, G.I.D.C. Vatva,
Ahmedabad 382 445 INDIA.
Официальный дистрибьютор в РФ:
ООО «Ханс Медикал Групп»
РФ, 214012, г. Смоленск, ул. Кашина, д.1, оф. 708
тел./факс: +7(495)2043552
e-mail: post@healthmedical.ru


I. Устройство для переливания крови (маркировка)

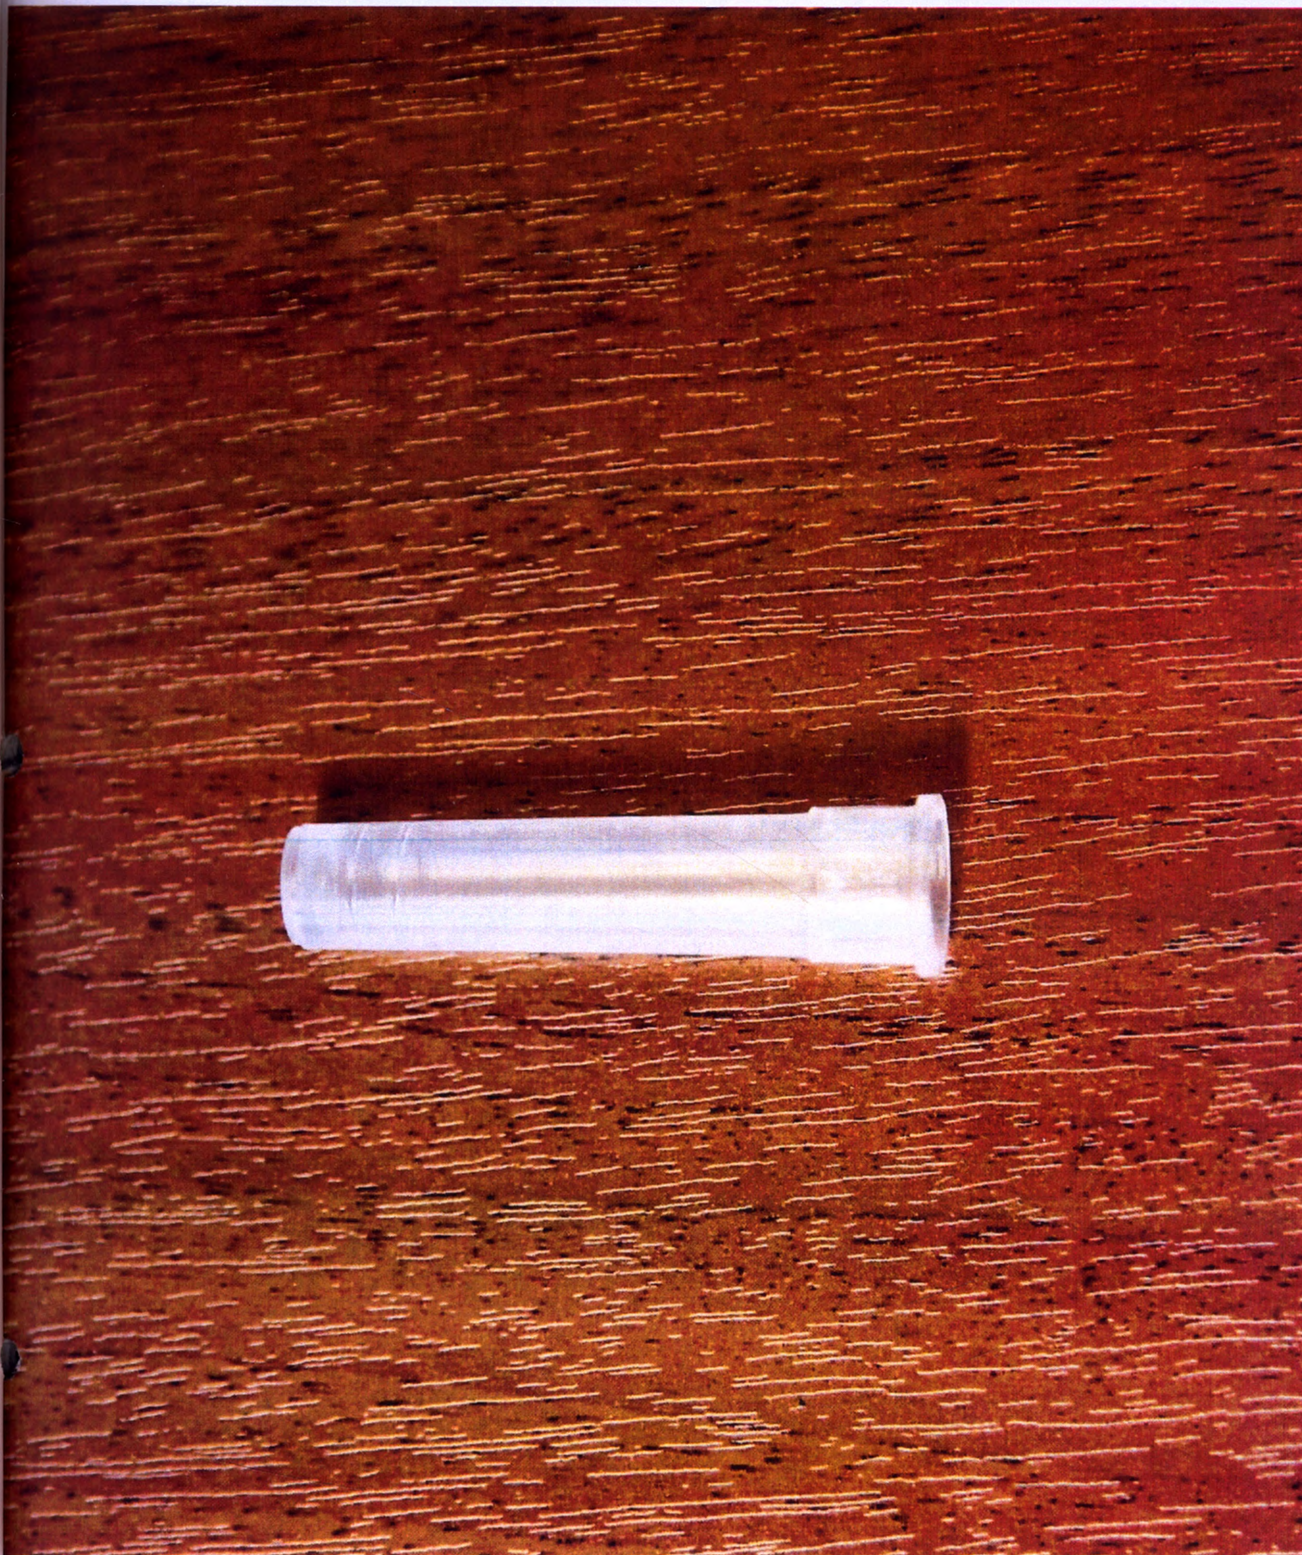


1- Предохранительный колпачок иглы для прокалывания крышки емкости 36 ± 1 мм

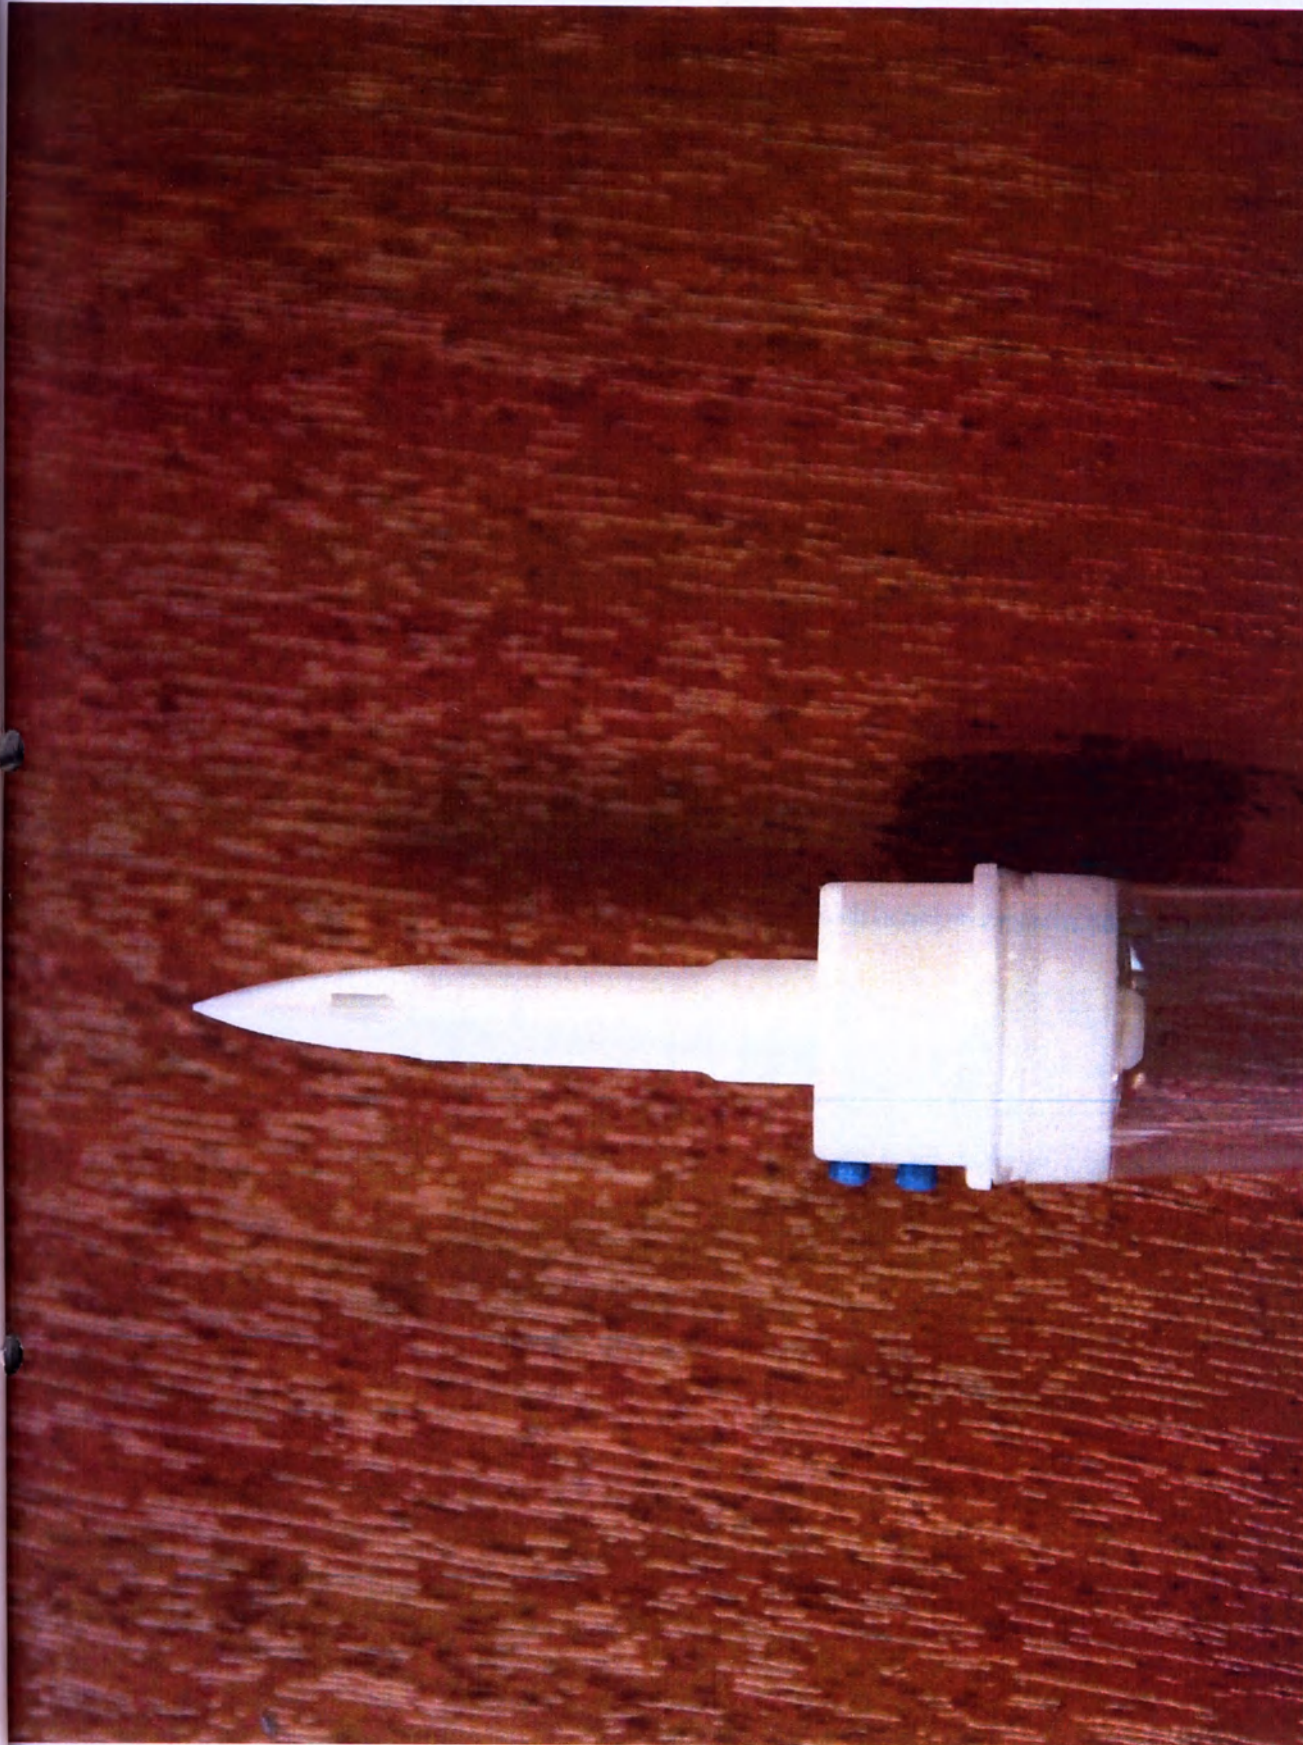


2- Игла для прокалывания крышки емкости 27-29 мм

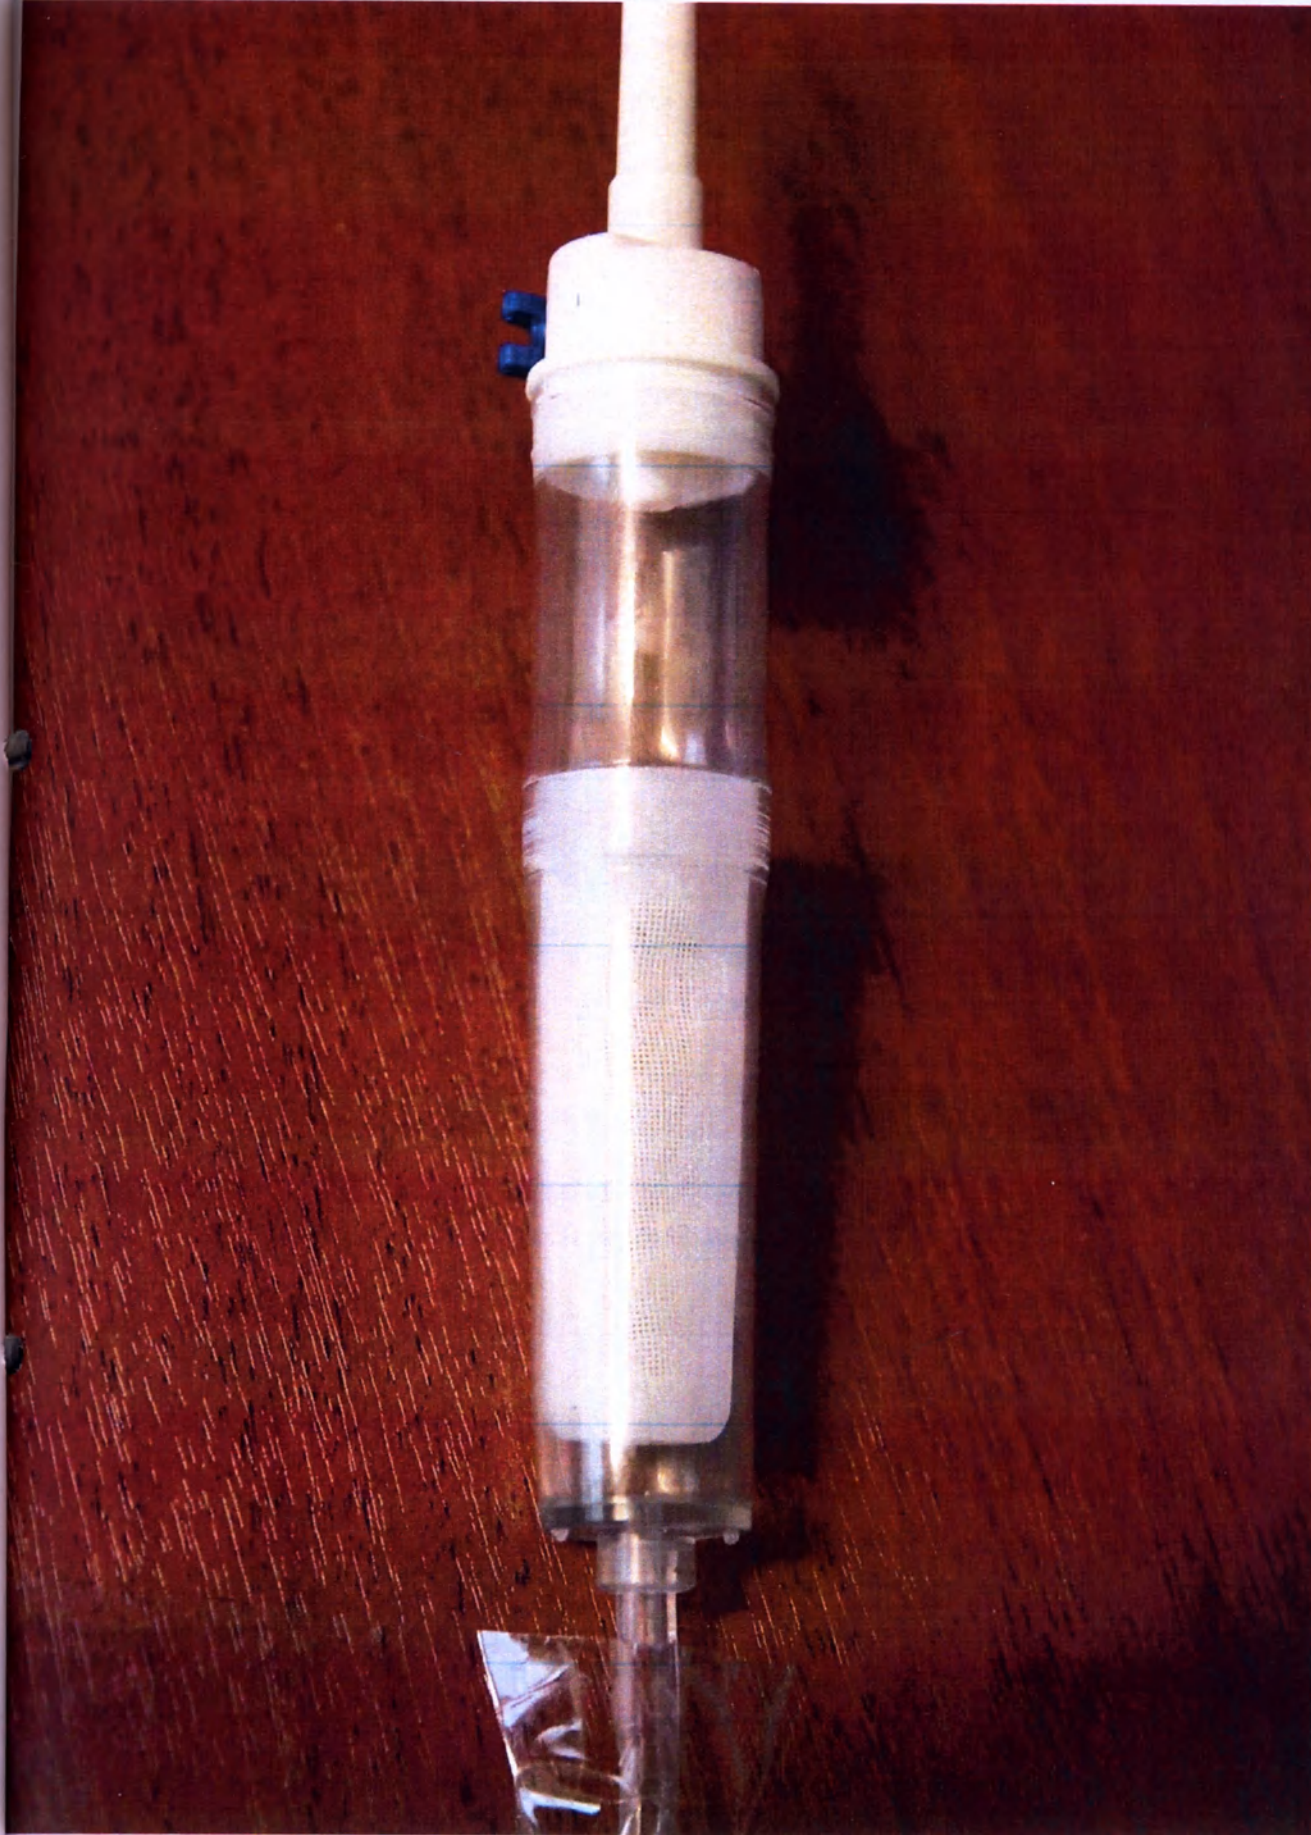

3-Капельница ≥ 80 мм

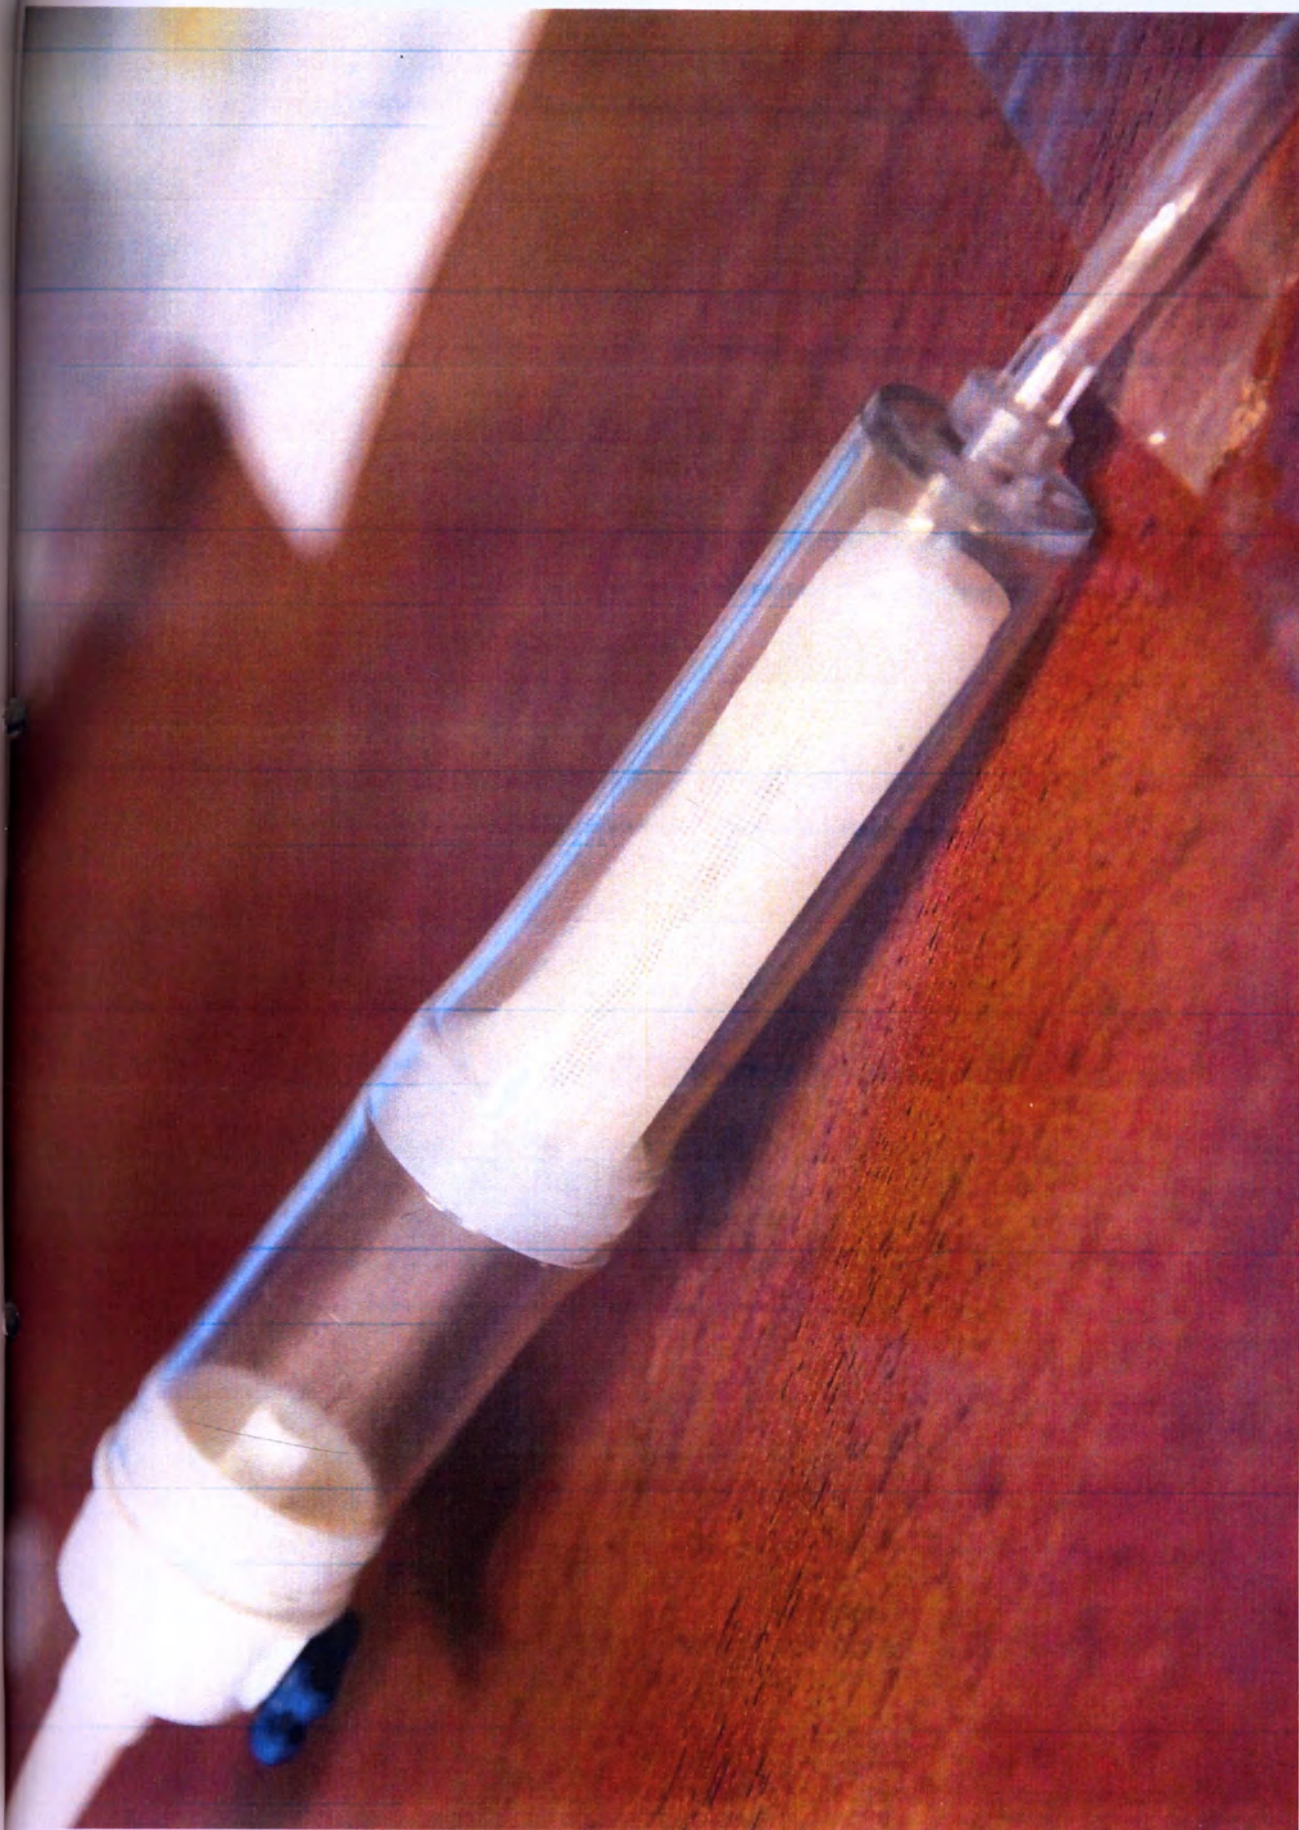

4- Фильтр крови ≥ 45 мм

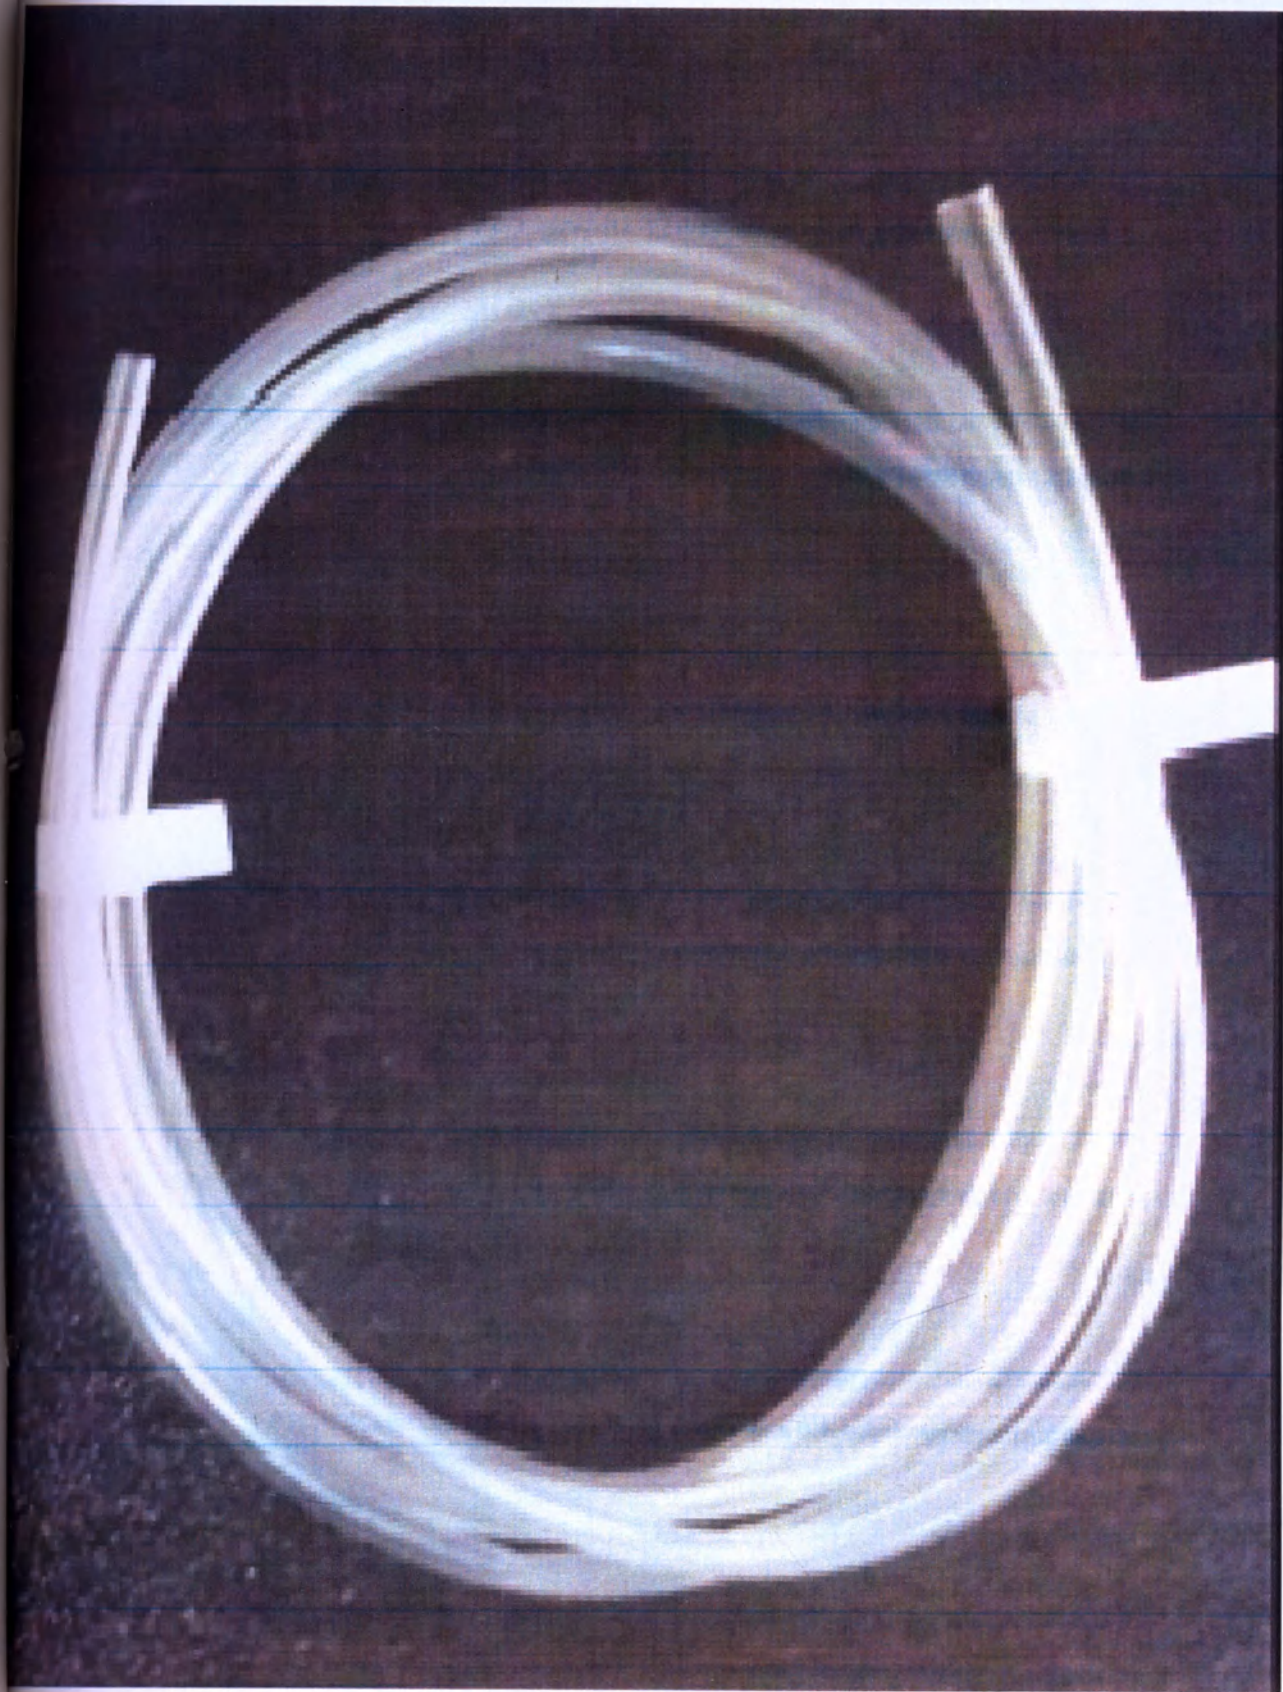

5- Соединительная трубка 1500 ± 20 мм




6- Место инъекции ≥ 40 мм




7- Коннектор типа Луер ≥ 20 мм



8- Регулятор скорости инфузии с зажимом 46,02 мм

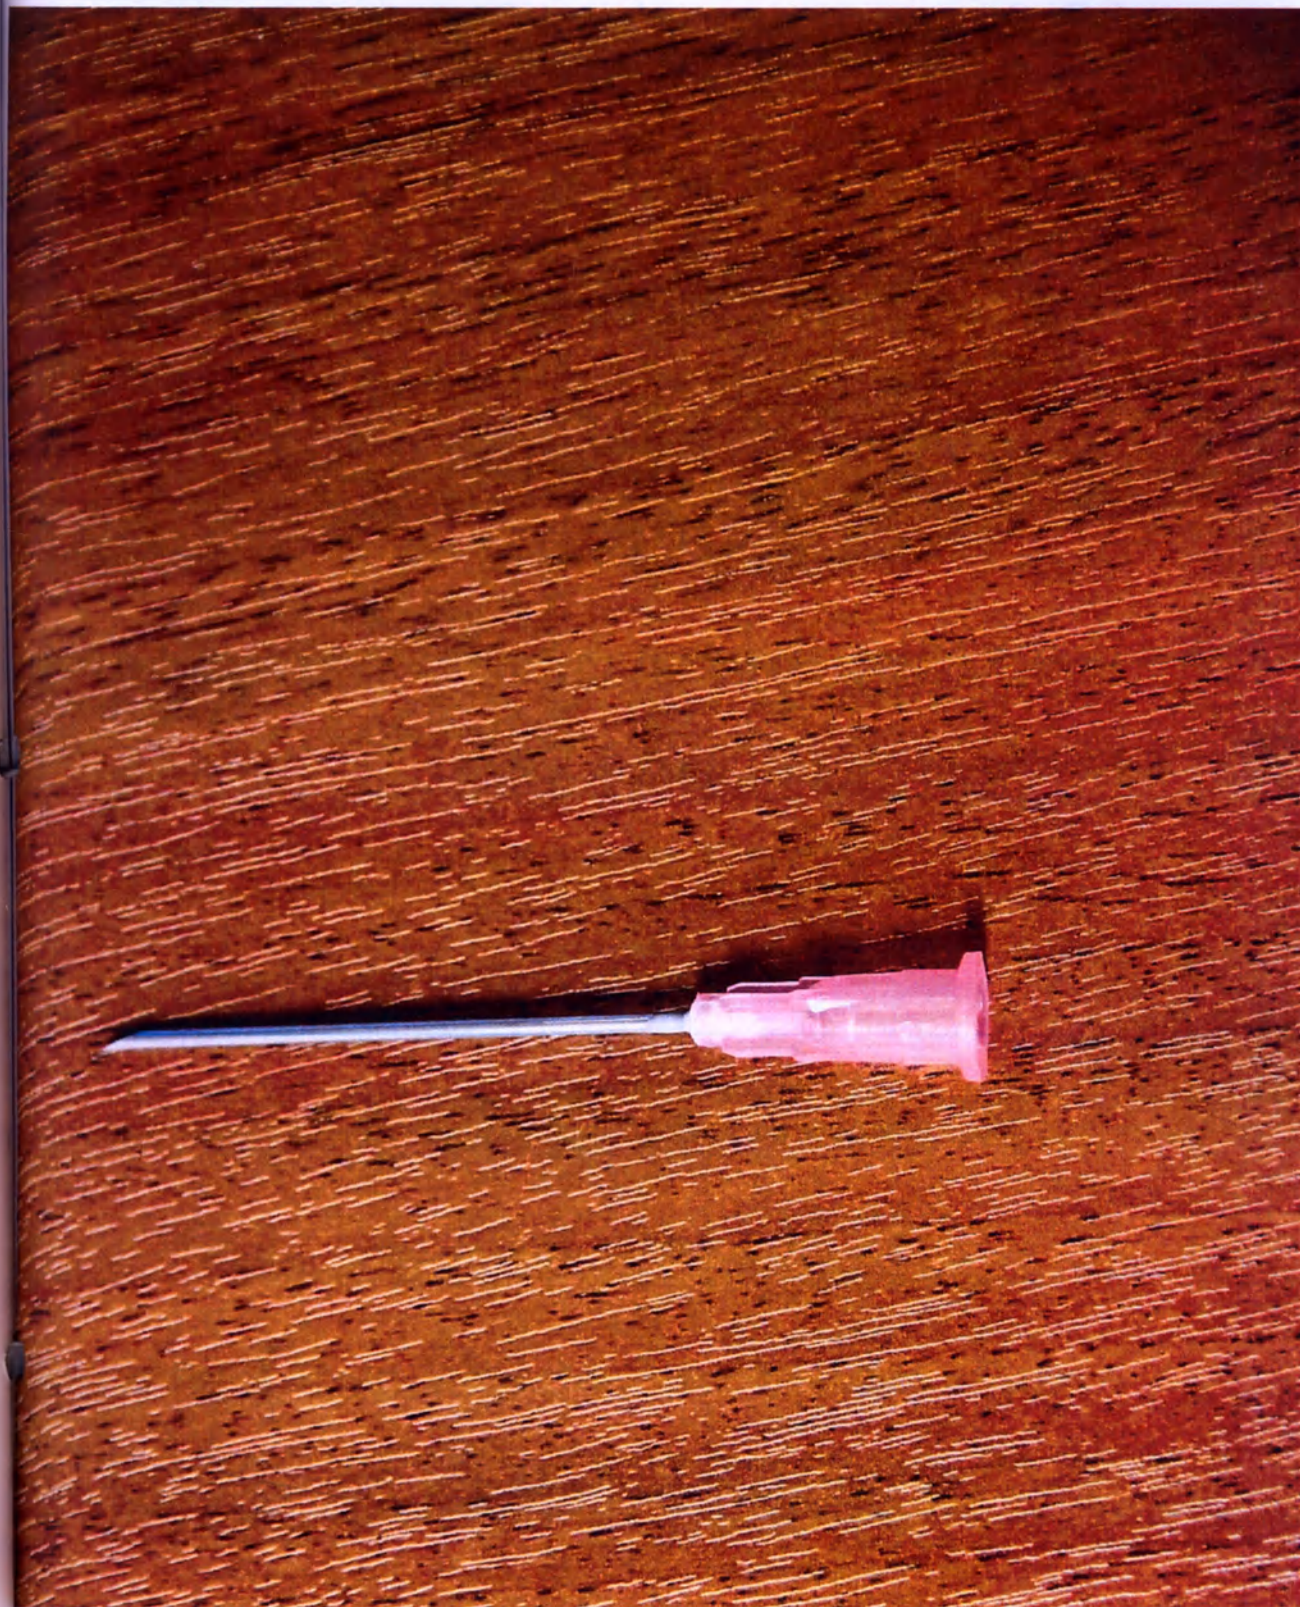

9- Игла 18G (Ø 1,21-1,3 мм x L 36-40 мм), 21G (Ø 0,80-0,83 мм x L 36-40 мм)

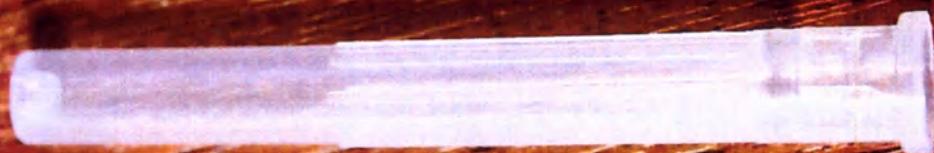

10- Предохранительный колпачок иглы 54,16 мм



11- Воздушный фильтр



II. Устройство для переливания инфузионных растворов



II. Устройство для переливания инфузионных растворов (в упаковке)



Angeltouch

Устройство для переливания инфузионных растворов
ру № ФСЗ 2012/12179 от ДД.ММ.ГГГГ

Мірна: 216 x 38-40 мм

ОДНОРАЗОВОЕ. АПИРОГЕННО. НЕТОКСИЧНО.
ГАРАНТИЯ СТЕРИЛЬНОСТИ. ЕСЛИ УПАКОВКА НЕ ПОВРЕЖДЕНА.

Предостережение (ВНИМАНИЕ):

- Изделие содержит «натуральные» латексы.
 - Не использовать для крошки и её компонентов.
 - Не использовать повторно.
- Не использовать, если упаковка вскрыта или повреждена
- Использовать после первого использования
- Опенок для гравитационного вливания растворов

Только для гравитационного влияния растворов.

хранить в прохладном сухом помещении.

- ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ:**
- Прорежьте/зафиксируйте входное отверстие емкости
 - Плотно закройте вентиляционное отверстие и розливочный зажим
 - Вставьте систему в емкость в вертикальном положении

НЕ ЗАПОЛНЯТЬ ПОЛНОСТЬЮ!

- Открыть заступку вентиляционного отверстия и розничной заправки с целью удаления воздуха из магистрали.

недостатком является раствор в системе

- В случае использования полициклических пакетов с реактором вентиляционное отверстие не открывать! Предостережение: вентиляция и отрегулировать скорость диффузии посредством зажима.

Разработано для введения растительное со средстве 20 лет. Апп



ANGIPLAST




At 80 Years Celebrated Company




© 2007 The Authors
Journal compilation © 2007 Blackwell Publishing Ltd



1- Предохранительный колпачок иглы для забора жидкости 35 ± 2 мм

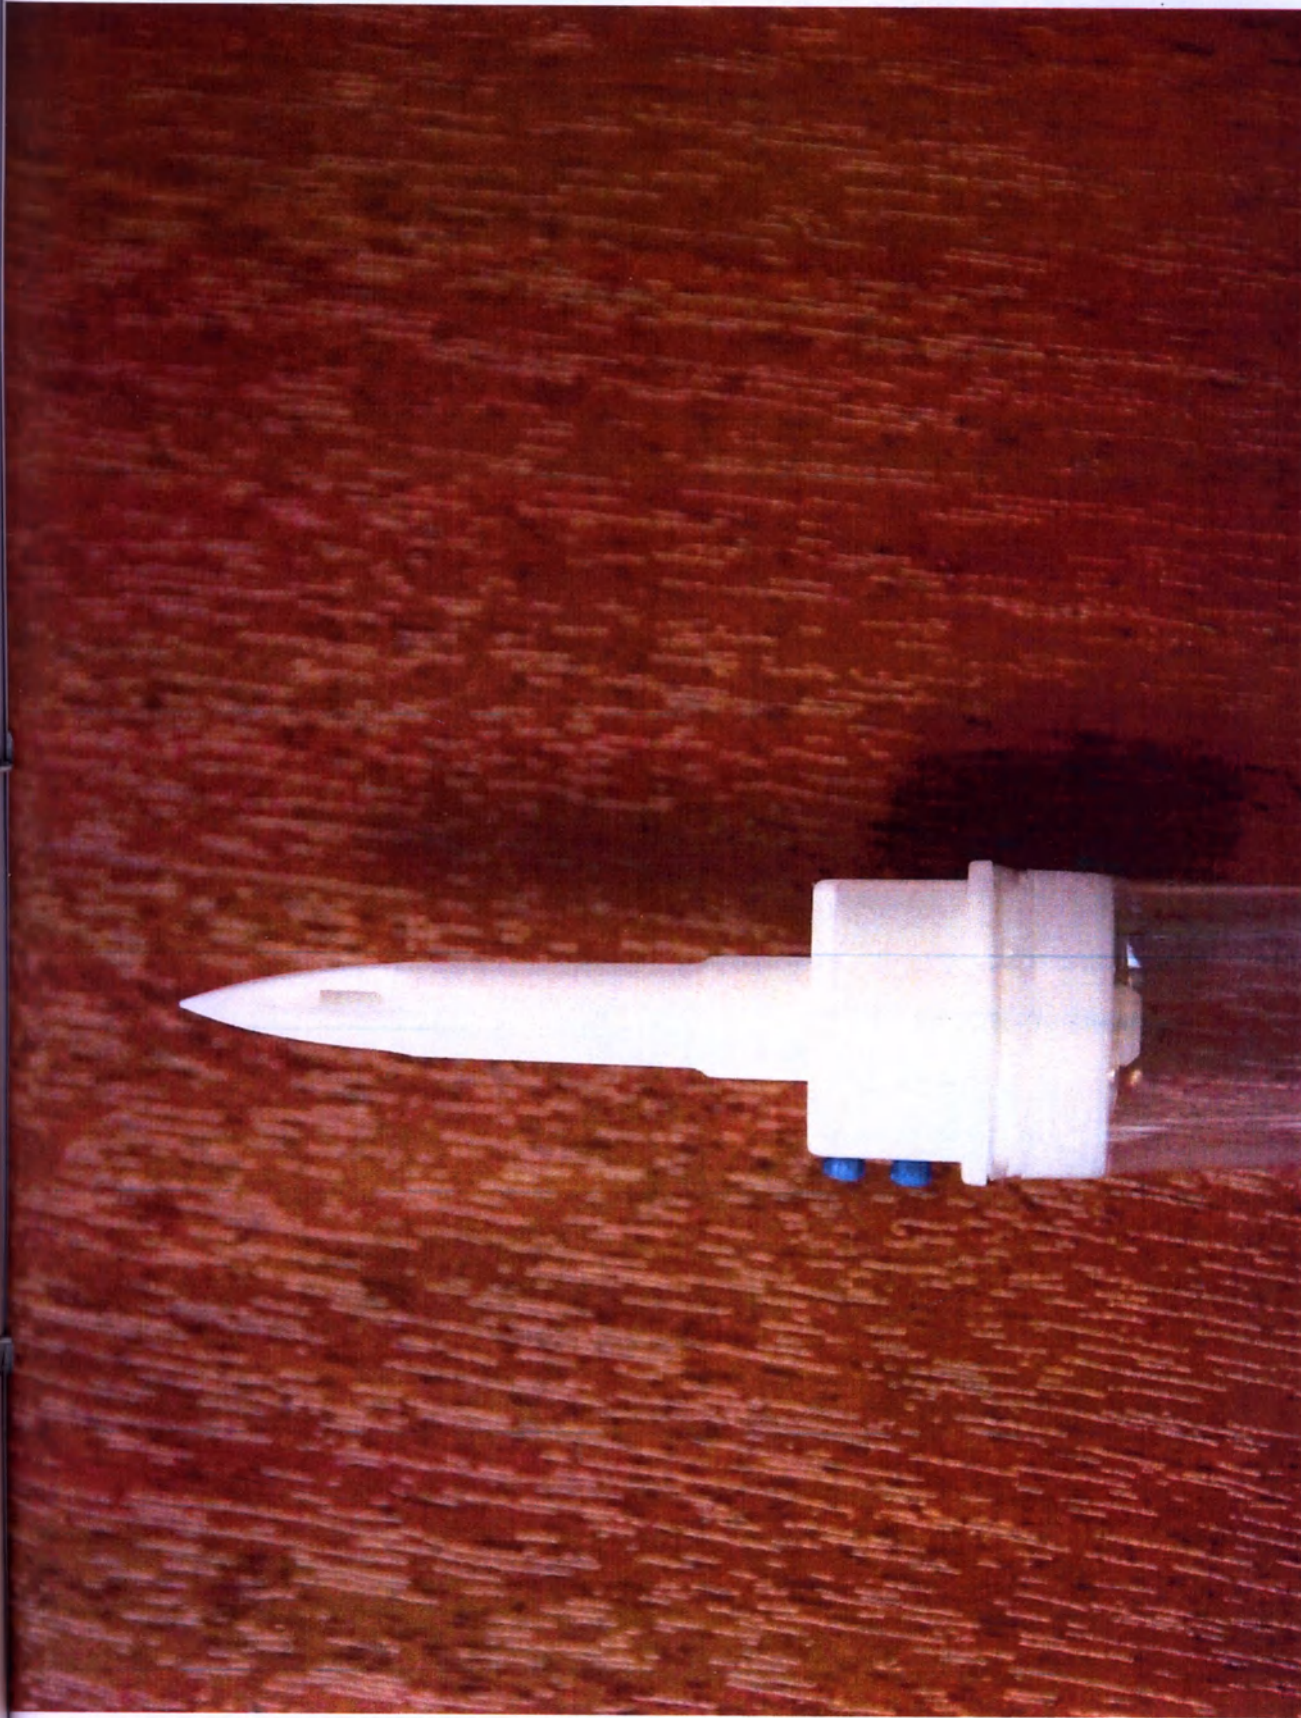

2-Игла для забора жидкости 27-29 мм

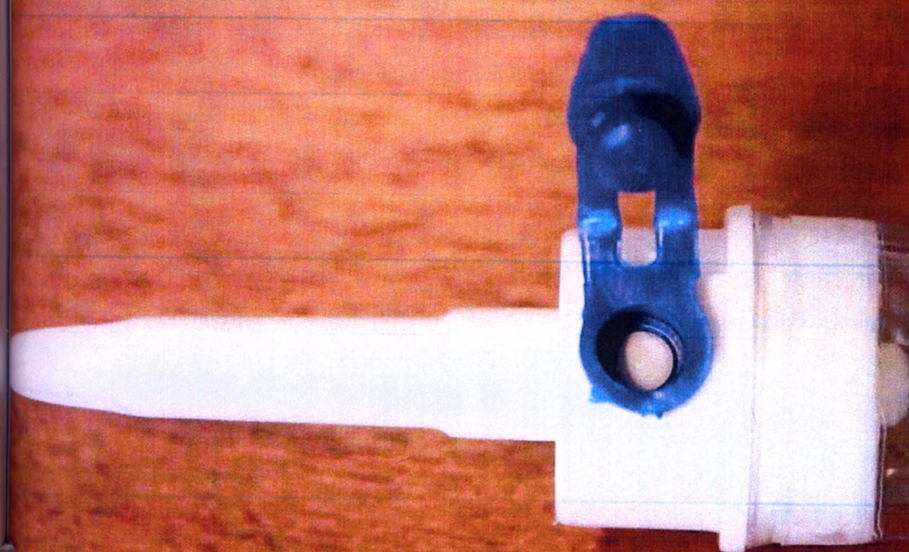


3-Держатель воздушного фильтра 5,8 мм



4-Воздушный фильтр




5-Капельница 50 ± 2 мм

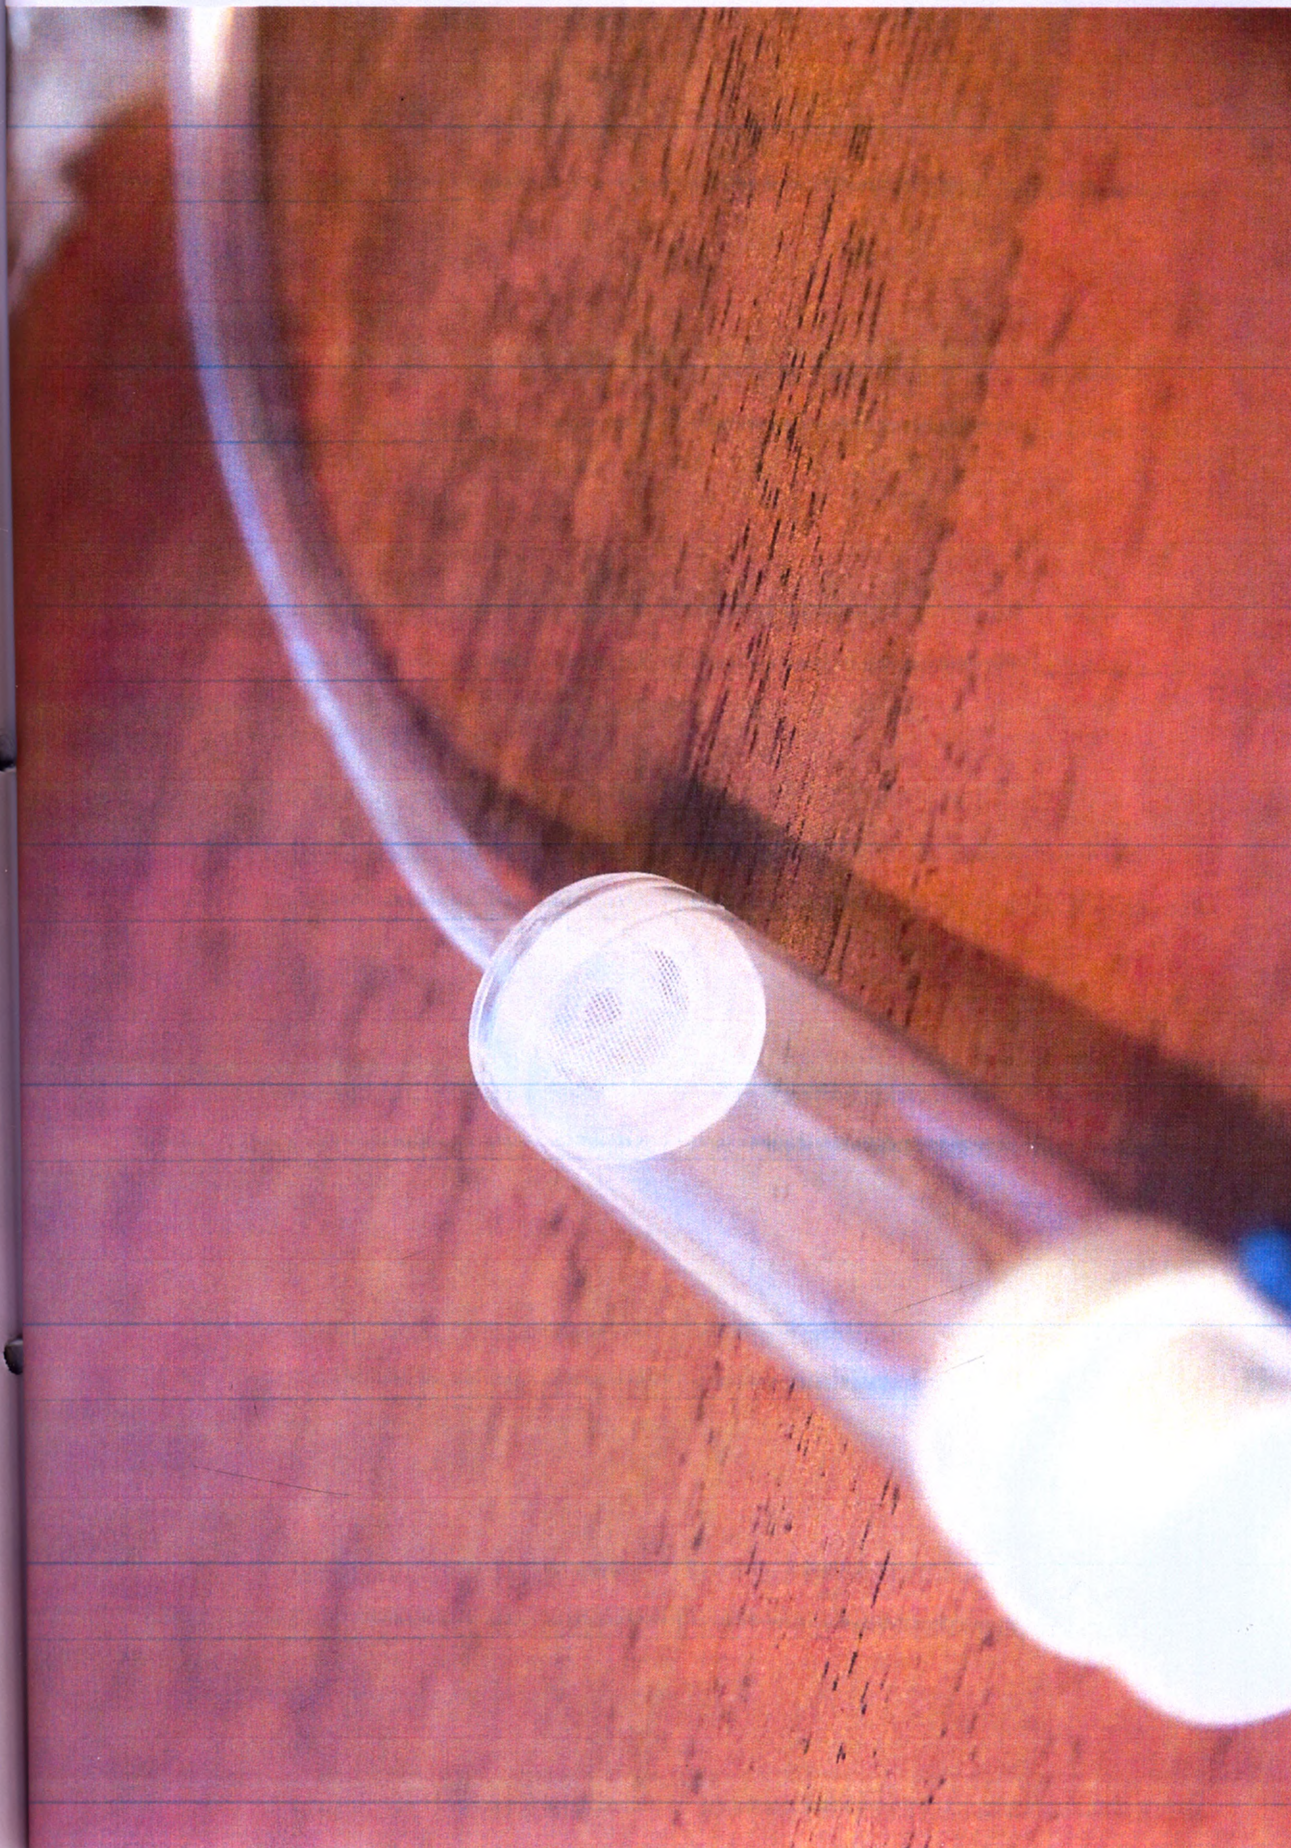


6-Фильтр жидкости 3,06 мм




7-Соединительная трубка 1500±20 мм

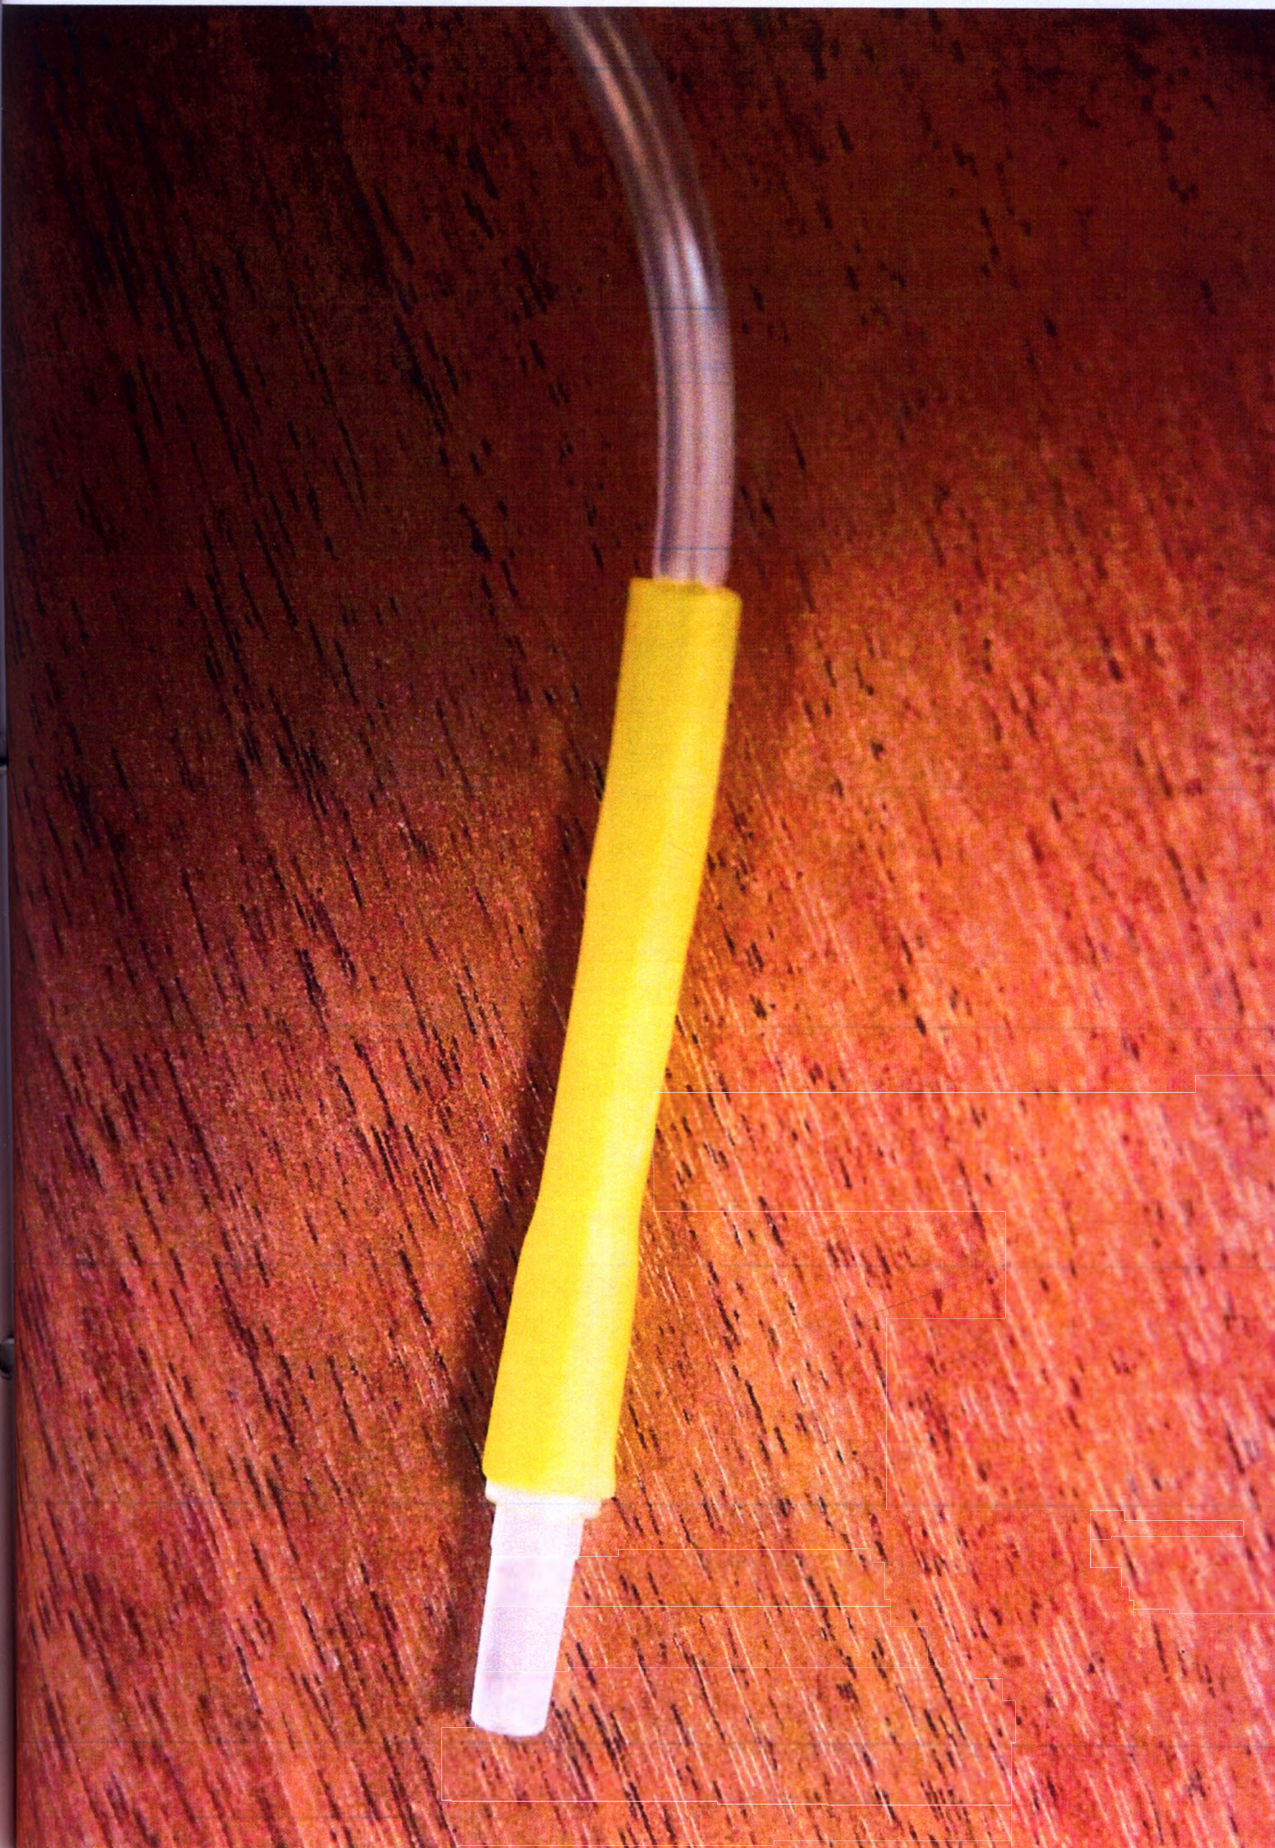


8-Место инъекции ≥ 50 мм

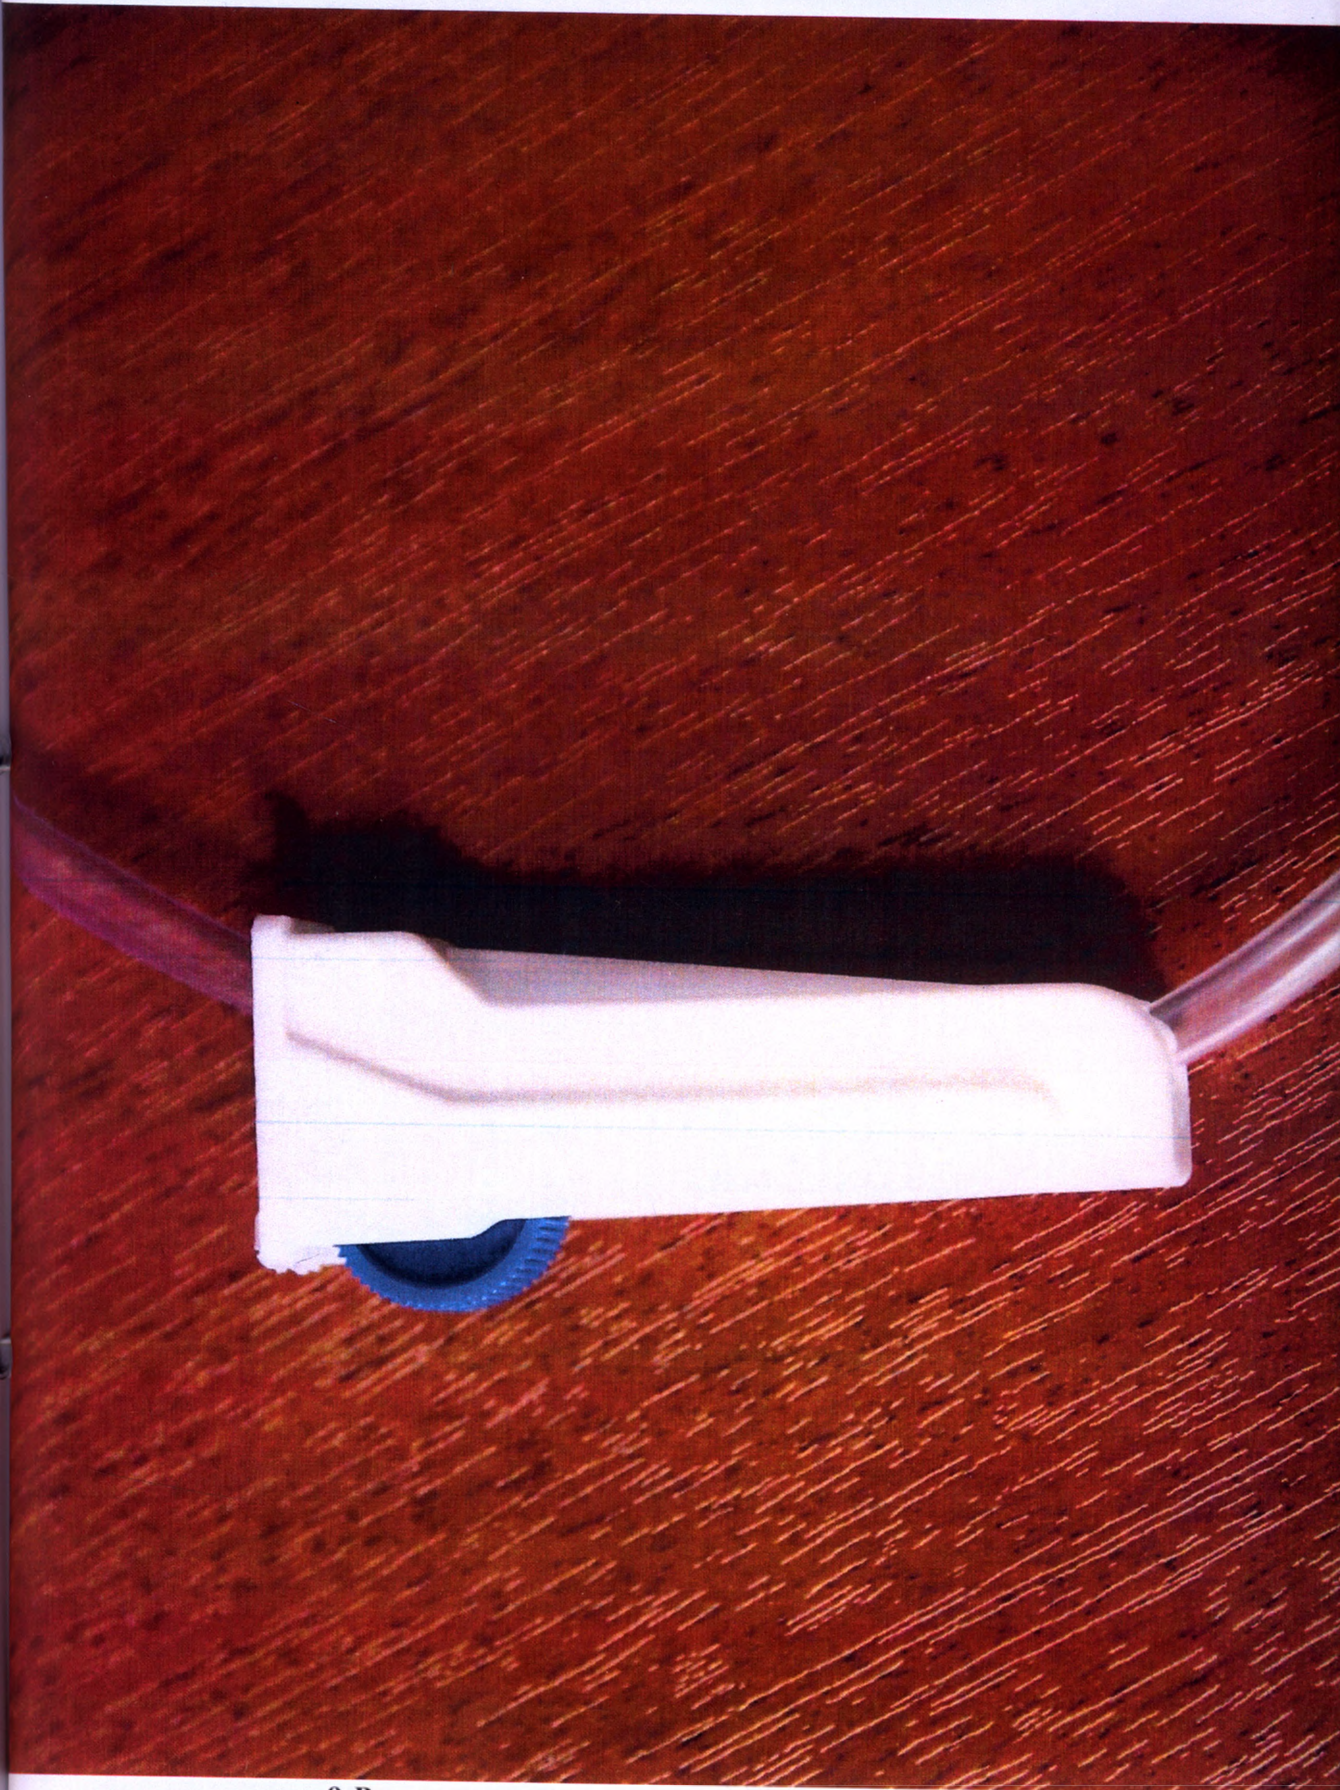


9-Регулятор скорости инфузии с зажимом 43 ± 2 мм

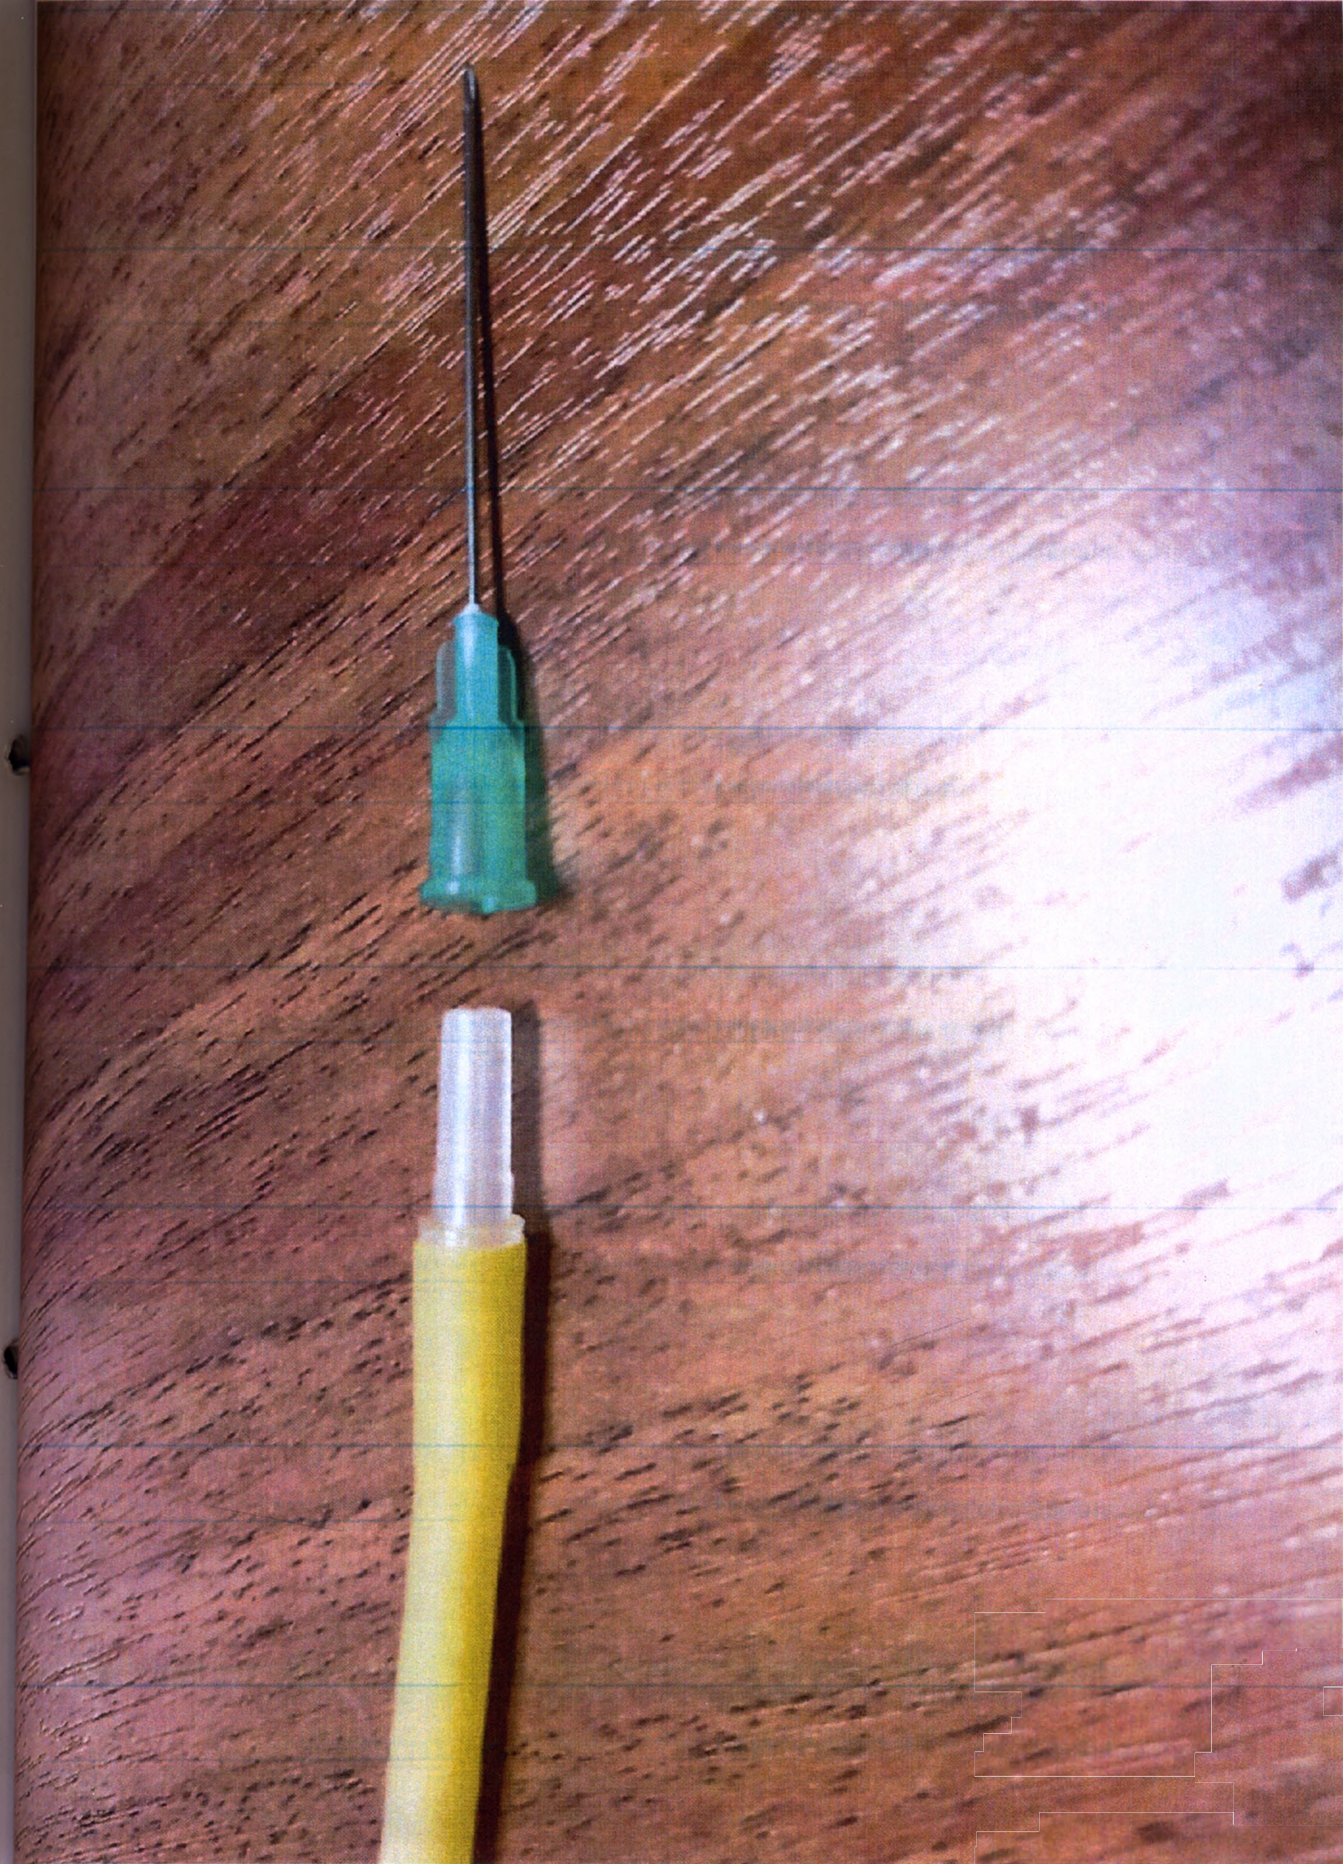


10-Коннектор типа Луер 21 ± 2 мм

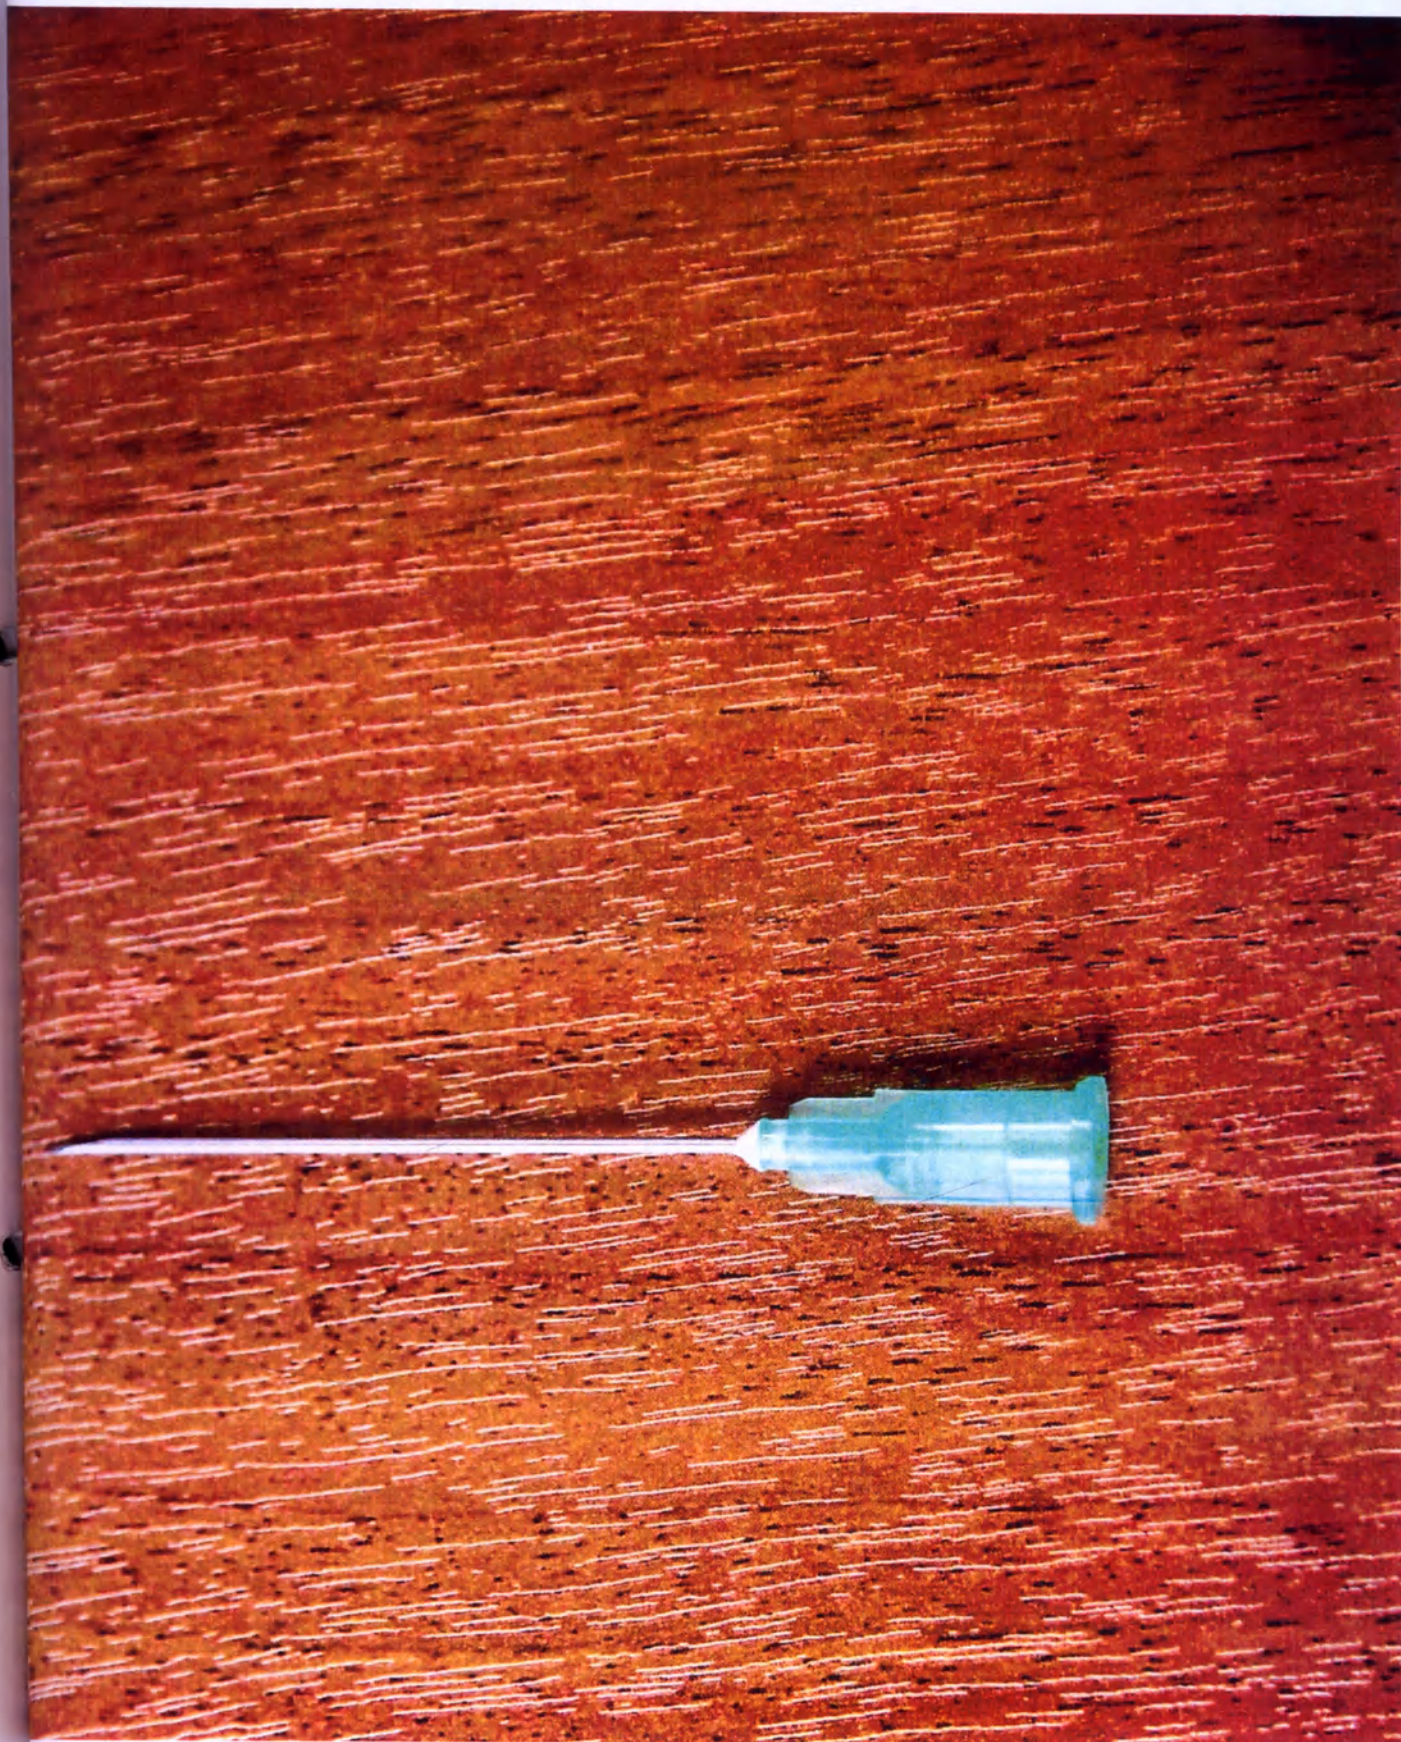


11- Игла 21G (Ø 0,80-0,83 мм x L 36-40 мм)

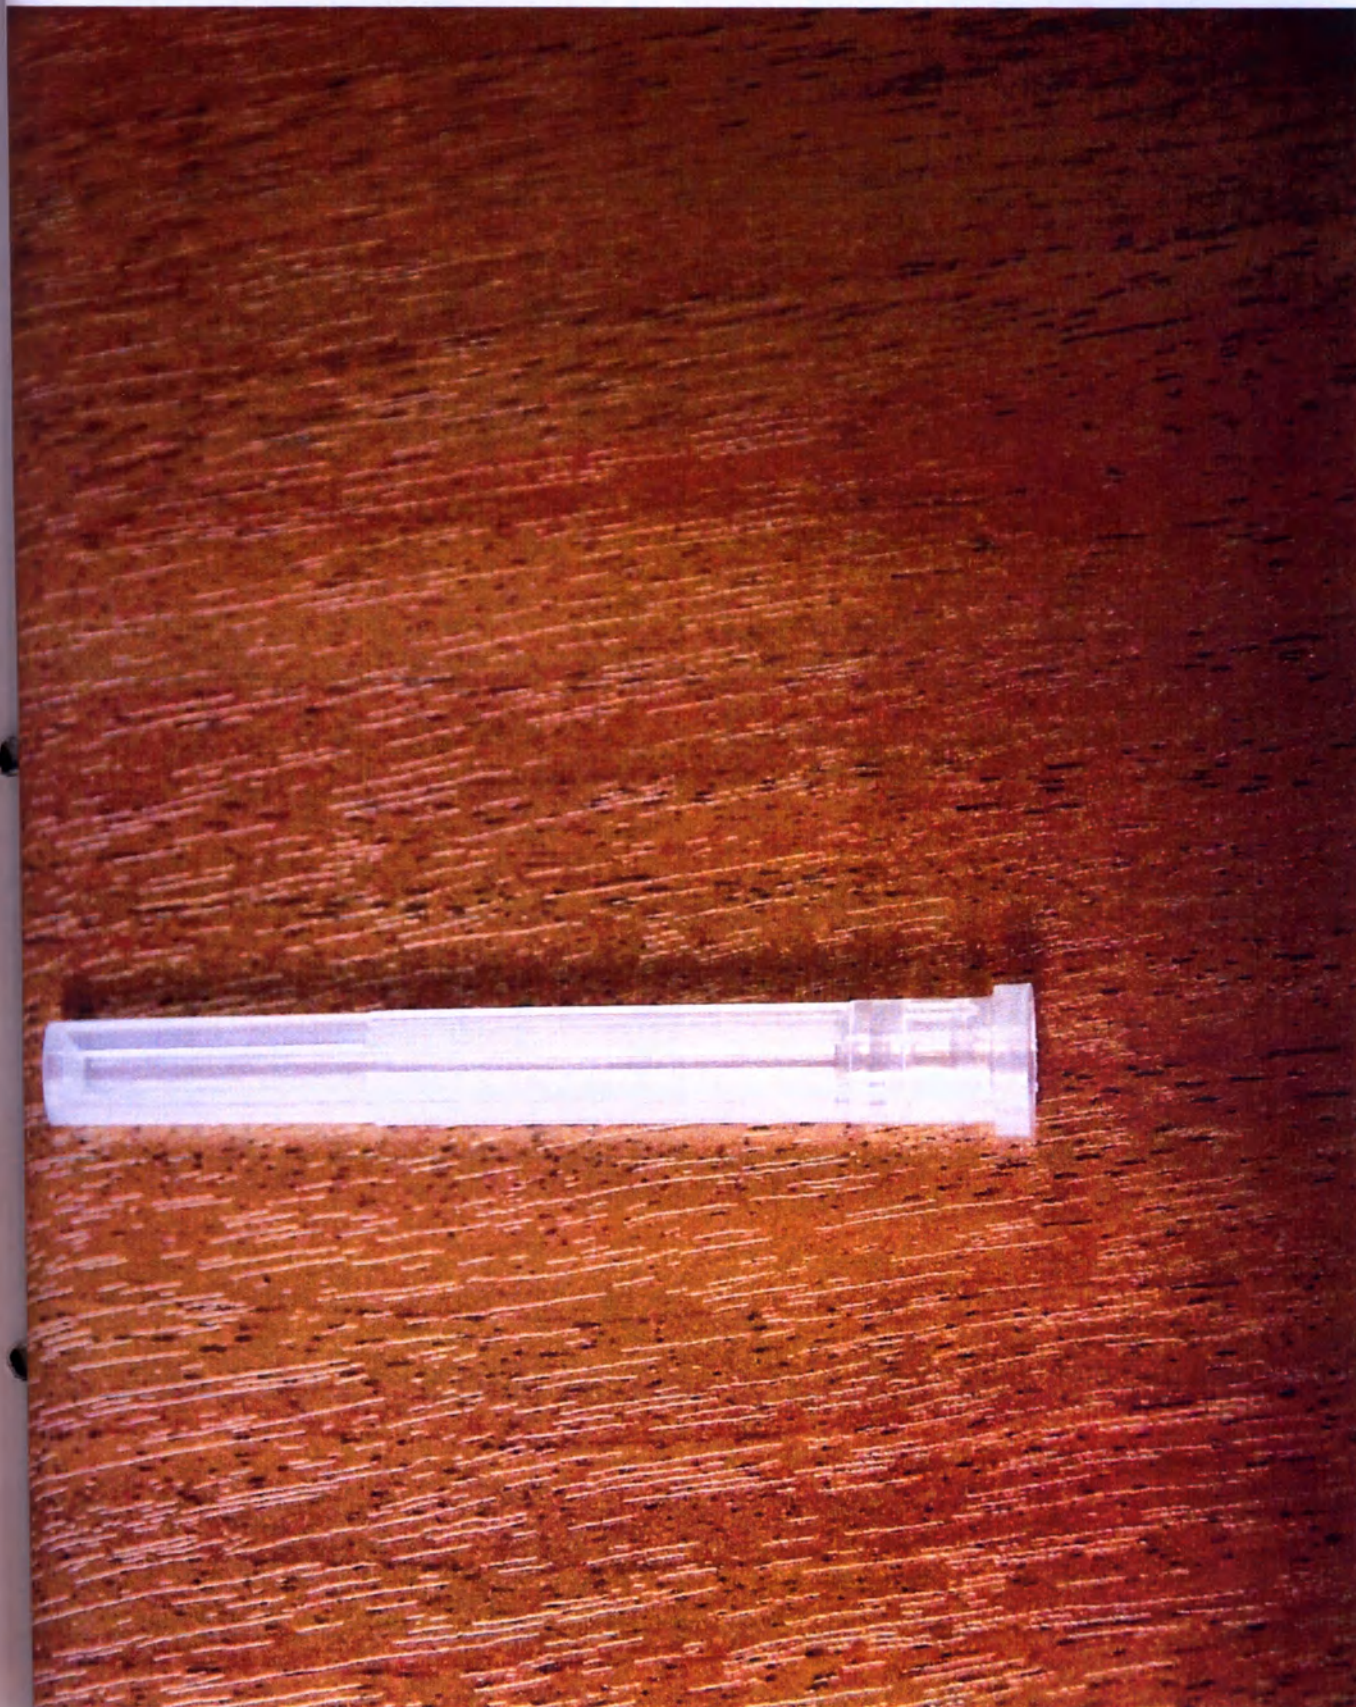

12- Предохранительный колпачок иглы 54,16 мм

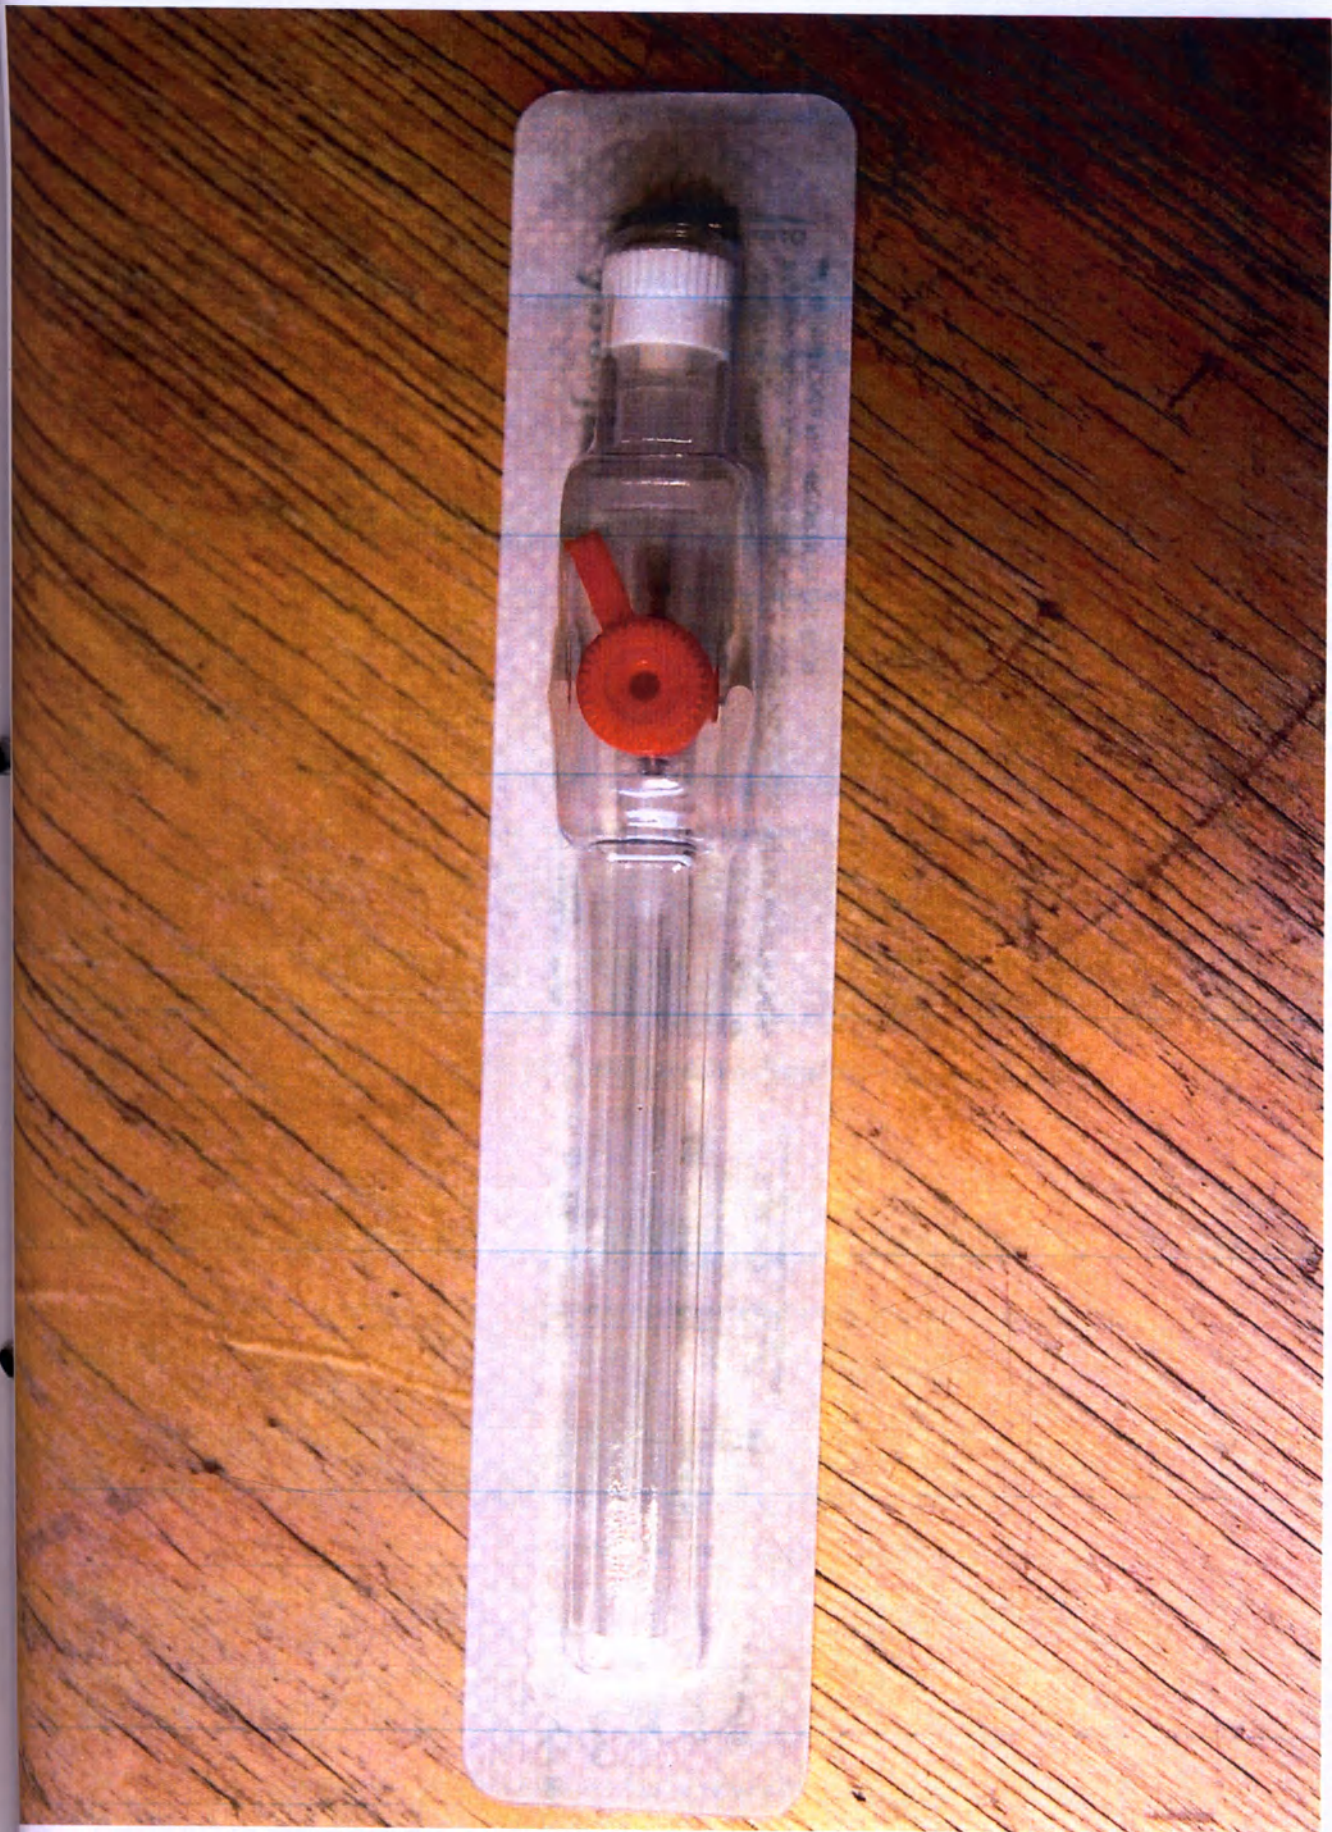

1- Катетер периферический с инъекционным портом и крылышками (в упаковке)

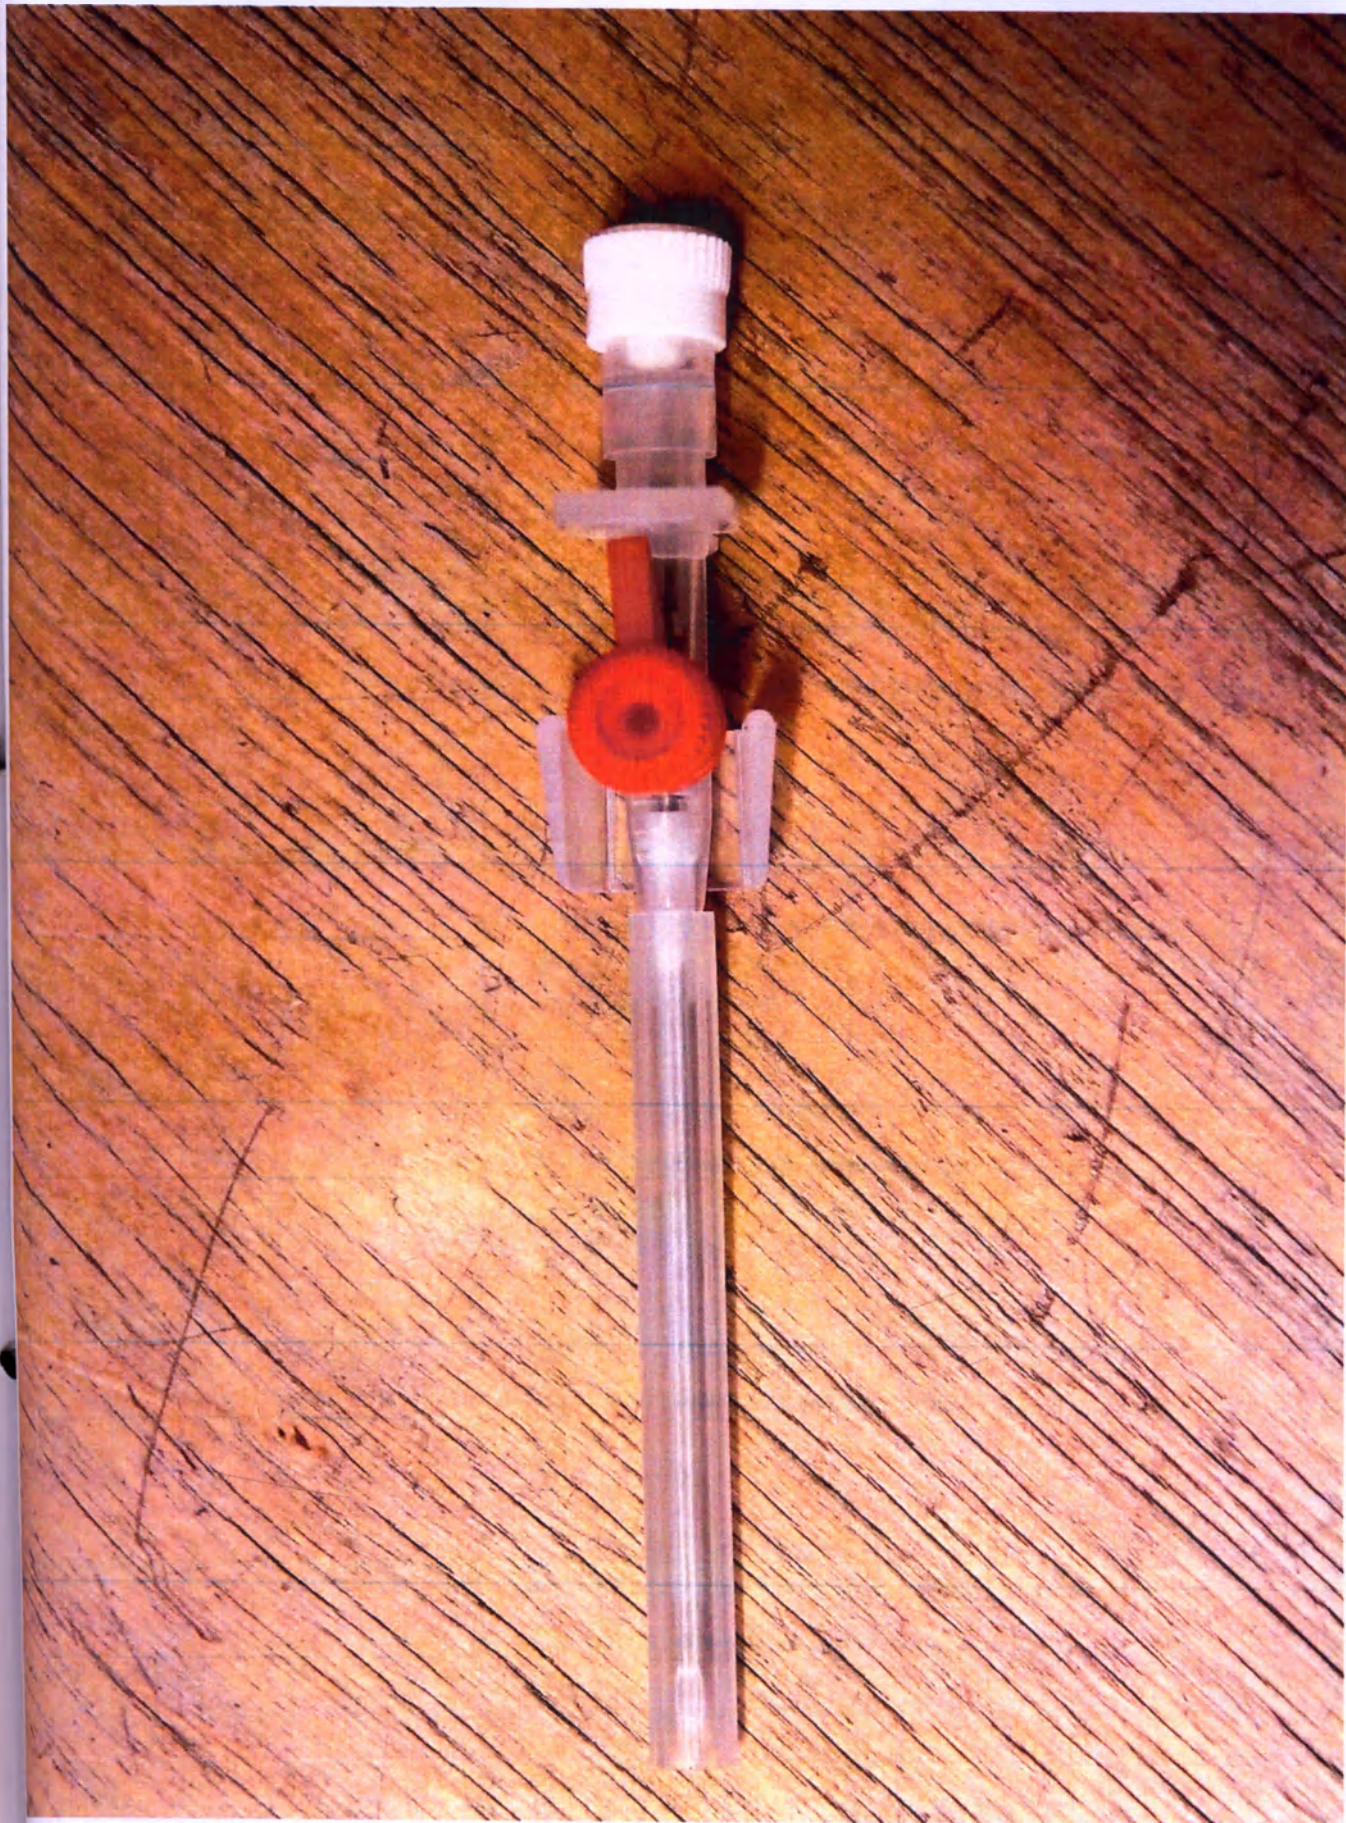

1.1-Катетер периферический с инъекционным портом и крылышками 14G (Ø 2,1 мм x L 45 мм)

1.1-Катетер периферический с инъекционным портом и крылышками 14G (Ø 2,1 мм x L 45 мм) (маркировка индивидуальной упаковки)


Angeltouch

Катетер периферический с инъекционным портом и крылышками

ЗАПРЕЩЕНО СНОВА ВВОДИТЬ В КАНЮЛЮ ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО ИЗВЛЕЧЕННУЮ ПРОВОДНИКОВУЮ ИГЛУ!

1. Достать катетер из защитной упаковки. 2. Произвести венепункцию. 3. После того, как катетер будет установлен на месте должным образом, прозрачный отсек обратного оттока заполнится кровью. 4. Извлечь проводниковую иглу и подключить устройство для переливания инфузионных растворов. 5. Убедиться в правильности установки катетера. 6. Закрепить катетер полосками пластыря.

Neutral code:UK/Device/MFG/MD/2020/000008



Не содержит латекс



ANGIPLAST PRIVATE LIMITED
Plot No. 4803, Phase IV, GIDC Vatva
Ahmedabad-382 445, India
Angioplast Private Limited Индия
тел./факс: +9149512043552
e-mail: post@healthmedical.ru

РУ № ФСЗ 2012/12179 от ДДММГГГГ

Устройства одноразовые для переливания крови
инфузионных растворов с принадлежностями
Катетер периферический с
инъекционным портом и крылышками 14G

Размер (GxØxL): 14Gx2.1x45mm
Скорость
потока: 270ml/min




Номер
партии:



Дата
изготовления:



Годен до:

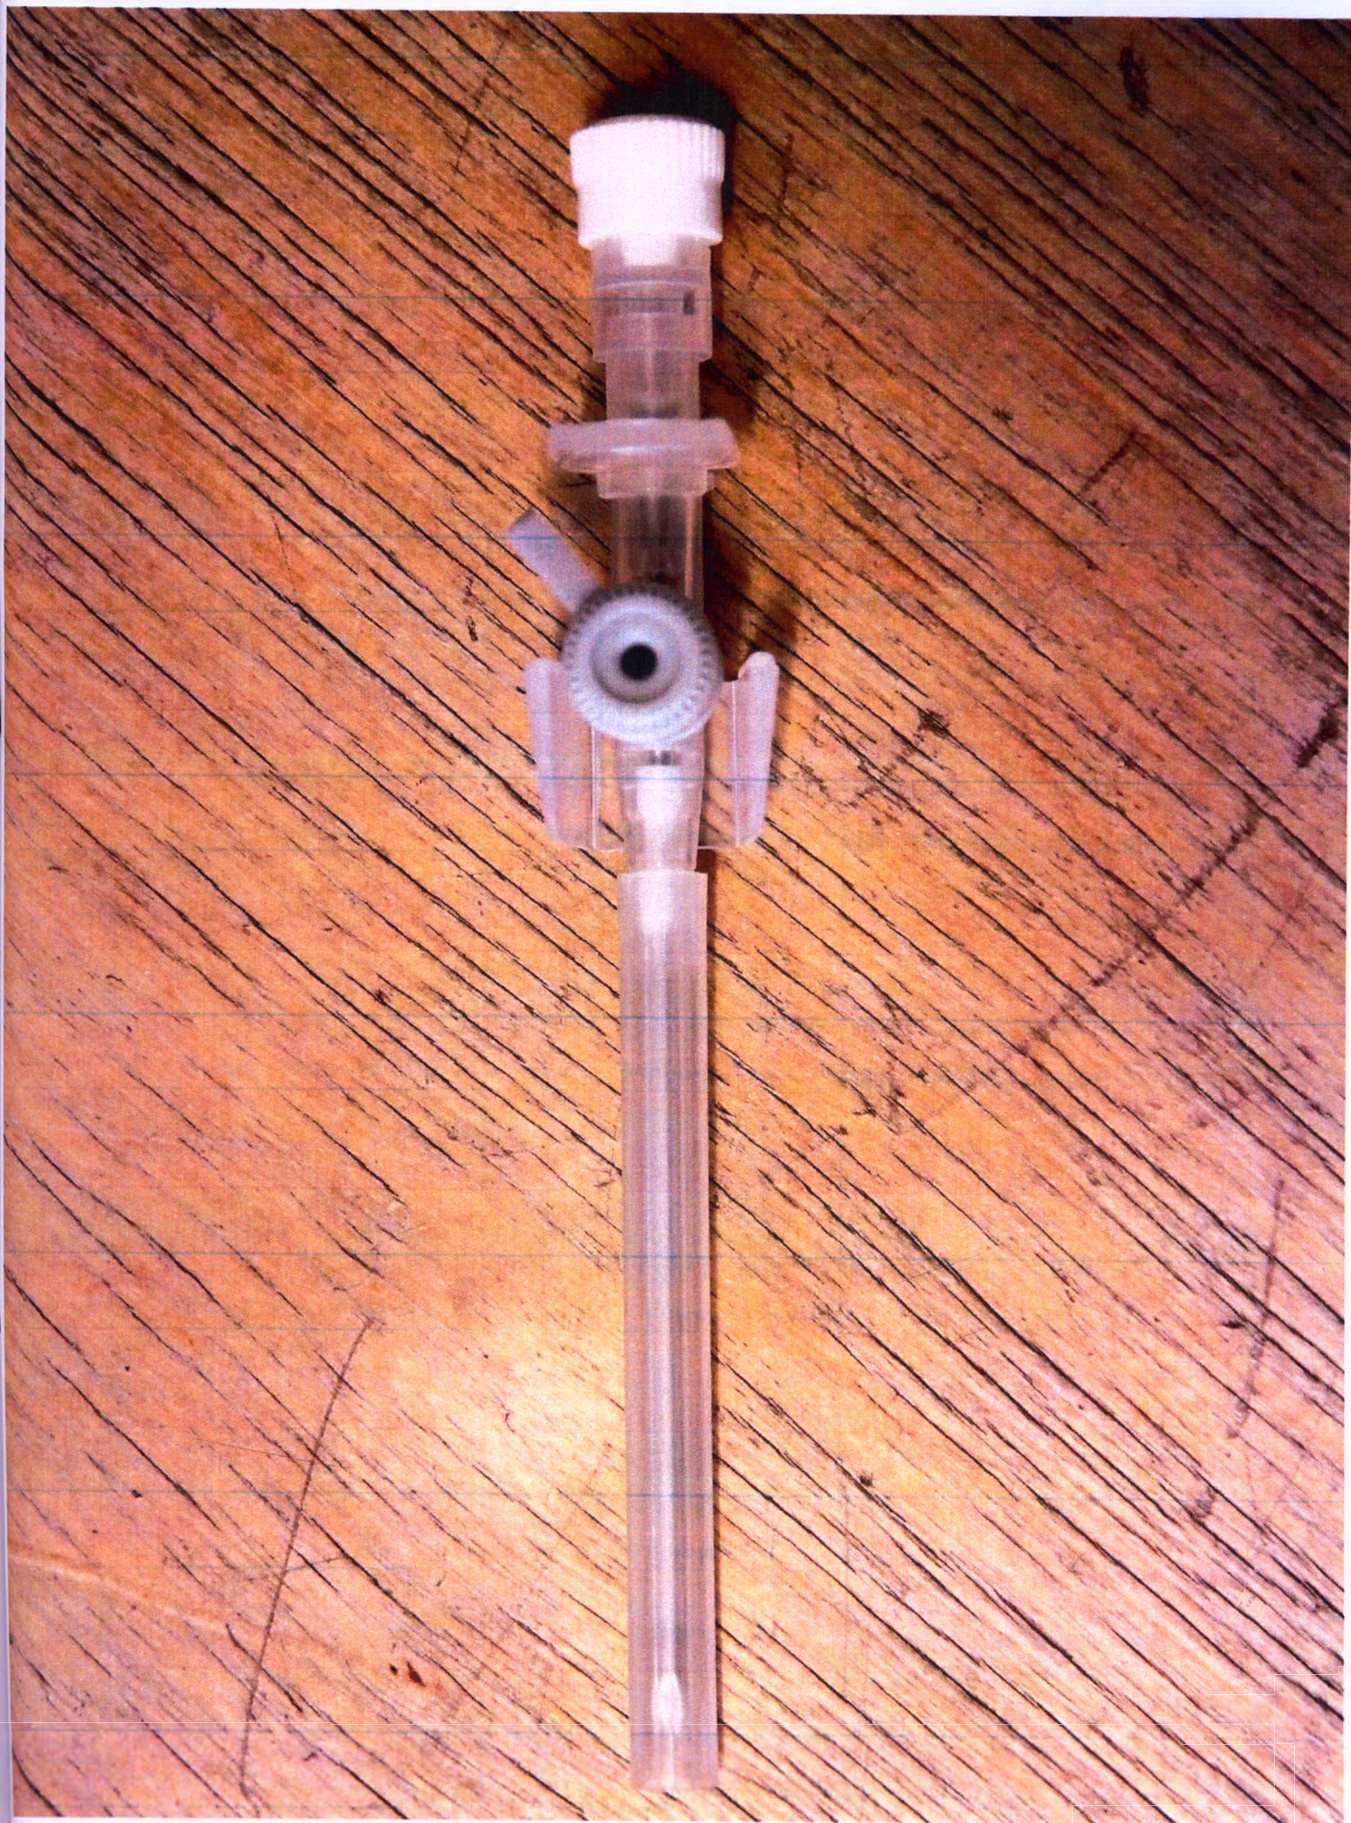

2-Катетер периферический с инъекционным портом и крылышками 16G (Ø 1,8 мм x L 45 мм)

2-Катетер периферический с инъекционным портом и крылышками 16G (Ø 1,8 мм x L 45 мм)
(маркировка)

ОТКРЫВАТЬ ЗДЕСЬ

Angeltouch

Катетер периферический с инъекционным портом и крылышками

ЗАПРЕЩЕНО СНОВА ВВОДИТЬ В КАНЮЛЮ ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО ИЗВЛЕЧЕННУЮ ПРОВОДНИКОВУЮ ИГЛУ!

1. Достать катетер из защитной упаковки. 2. Произвести венепункцию. 3. После того, как катетер будет установлен на месте должным образом, прозрачный отсек обратного оттока заполнится кровью. 4. Извлечь проводниковую иглу и подключить устройство для переливания инфузионных растворов. 5. Убедиться в правильности установки катетера. 6. Закрепить катетер полосками пластыря.

Neutral code:UK/Device/MFG/MD/2020/000008



CE
2460

ANGIPLAST PRIVATE LIMITED
Plot No. 4803, Phase IV, GIDC Vatva
Ahmedabad 382 445 India
Angioplast Private Limited Индия
тел. факс: +9149512043552
e-mail: post@healthmedical.ru

РУ № ФСЗ 2012/12179 от ДДММГГГГ

Устройства одноразовые для переливания крови,
инфузионных растворов с принадлежностями
Катетер периферический с
инъекционным портом и крылышками 16G

Размер (GxØxL): 16Gx1.8x45mm
Скорость
потока: 200ml/min




Номер
партии:



Дата
изготовления:

Годен до:

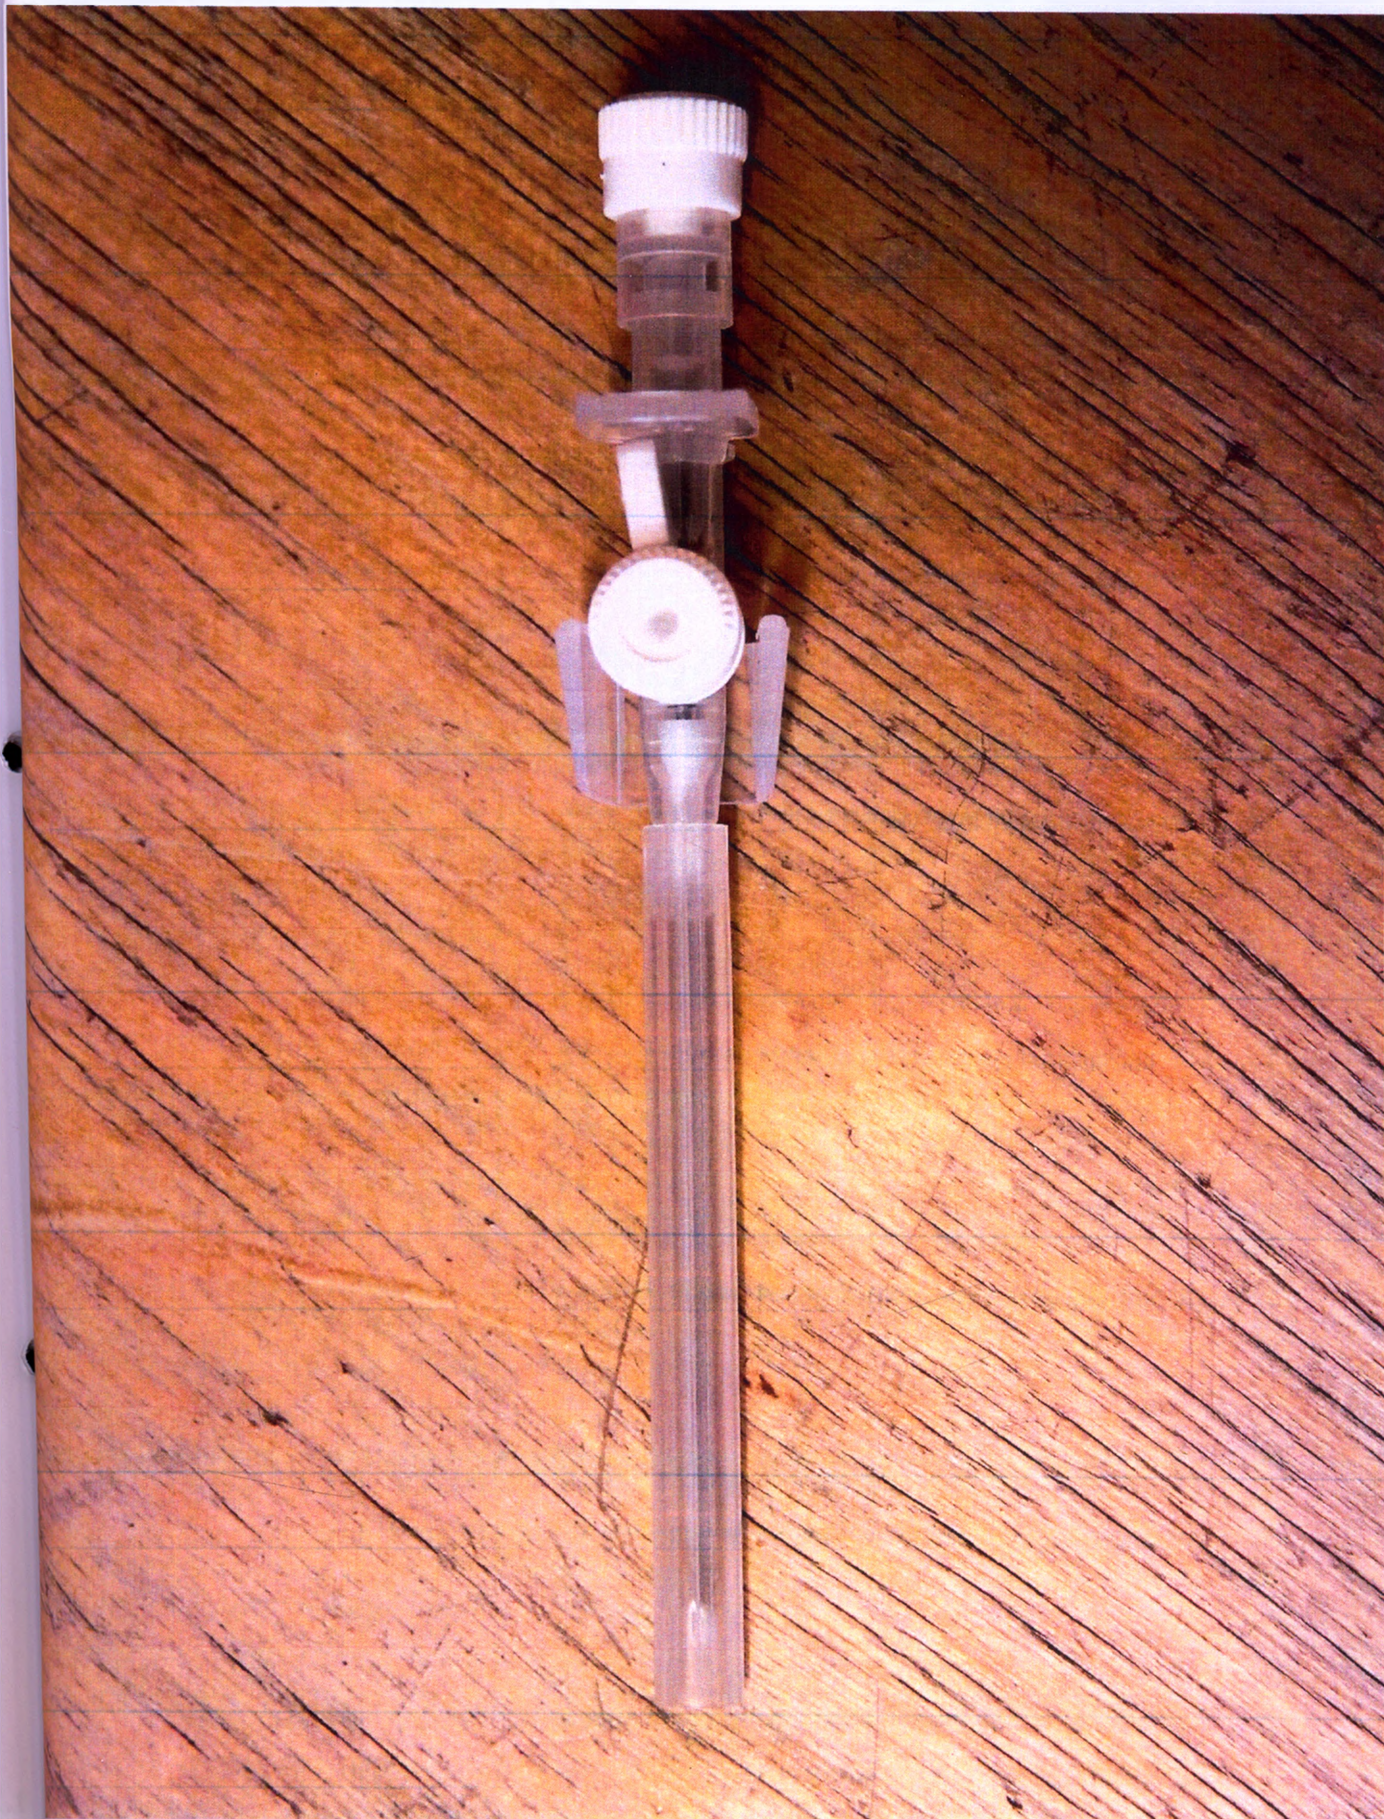

3-Катетер периферический с инъекционным портом и крыльшками 17G (Ø 1,5 мм x L 45 мм)

Катетер периферический с инъекционным портом и крылышками 17G (Ø 1,5 мм x L 45 см)
(маркировка)

ОТКРЫВАТЬ ЗДЕСЬ

Angeltouch

Катетер периферический с инъекционным портом и крылышками

ЗАПРЕЩЕНО СНОВА ВВОДИТЬ В КАНИЮЛЮ ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО ИЗВЛЕЧЕННУЮ ПРОВОДНИКОВУЮ ИГЛУ!

1. Достать катетер из защитной упаковки. 2. Произвести венепункцию. 3. После того, как катетер будет установлен на месте должным образом, прозрачный отсек обратного оттока заполнится кровью. 4. Извлечь проводниковую иглу и подключить устройство для переливания инфузионных растворов. 5. Убедиться в правильности установки катетера. 6. Закрепить катетер полосками пластыря.

Neutral code: UK/Device/MFG/MD/2020/000008



STERILE EO
Не содержит латекс

CE
2460

ANGIPLAST PRIVATE LIMITED
Plot No. 4803, Phase IV, GIDC Varva,
Ahmedabad 382 445 India
Angioplast Private Limited Индия
tel: факс: +91 79 49512043552
e-mail: post@healthmedical.ru

РУ № ФСЗ 2012/12179 от ДДММГГГГ

Устройства одноразовые для переливания крови,
инфузионных растворов с принадлежностями.
Катетер периферический с
инъекционным портом и крылышками 17G

Размер (GxØxL): 17Gx1.5x45mm

Скорость
потока: 125ml/min

LOT


Номер
партии:



Дата
изготовления:



Годен до:

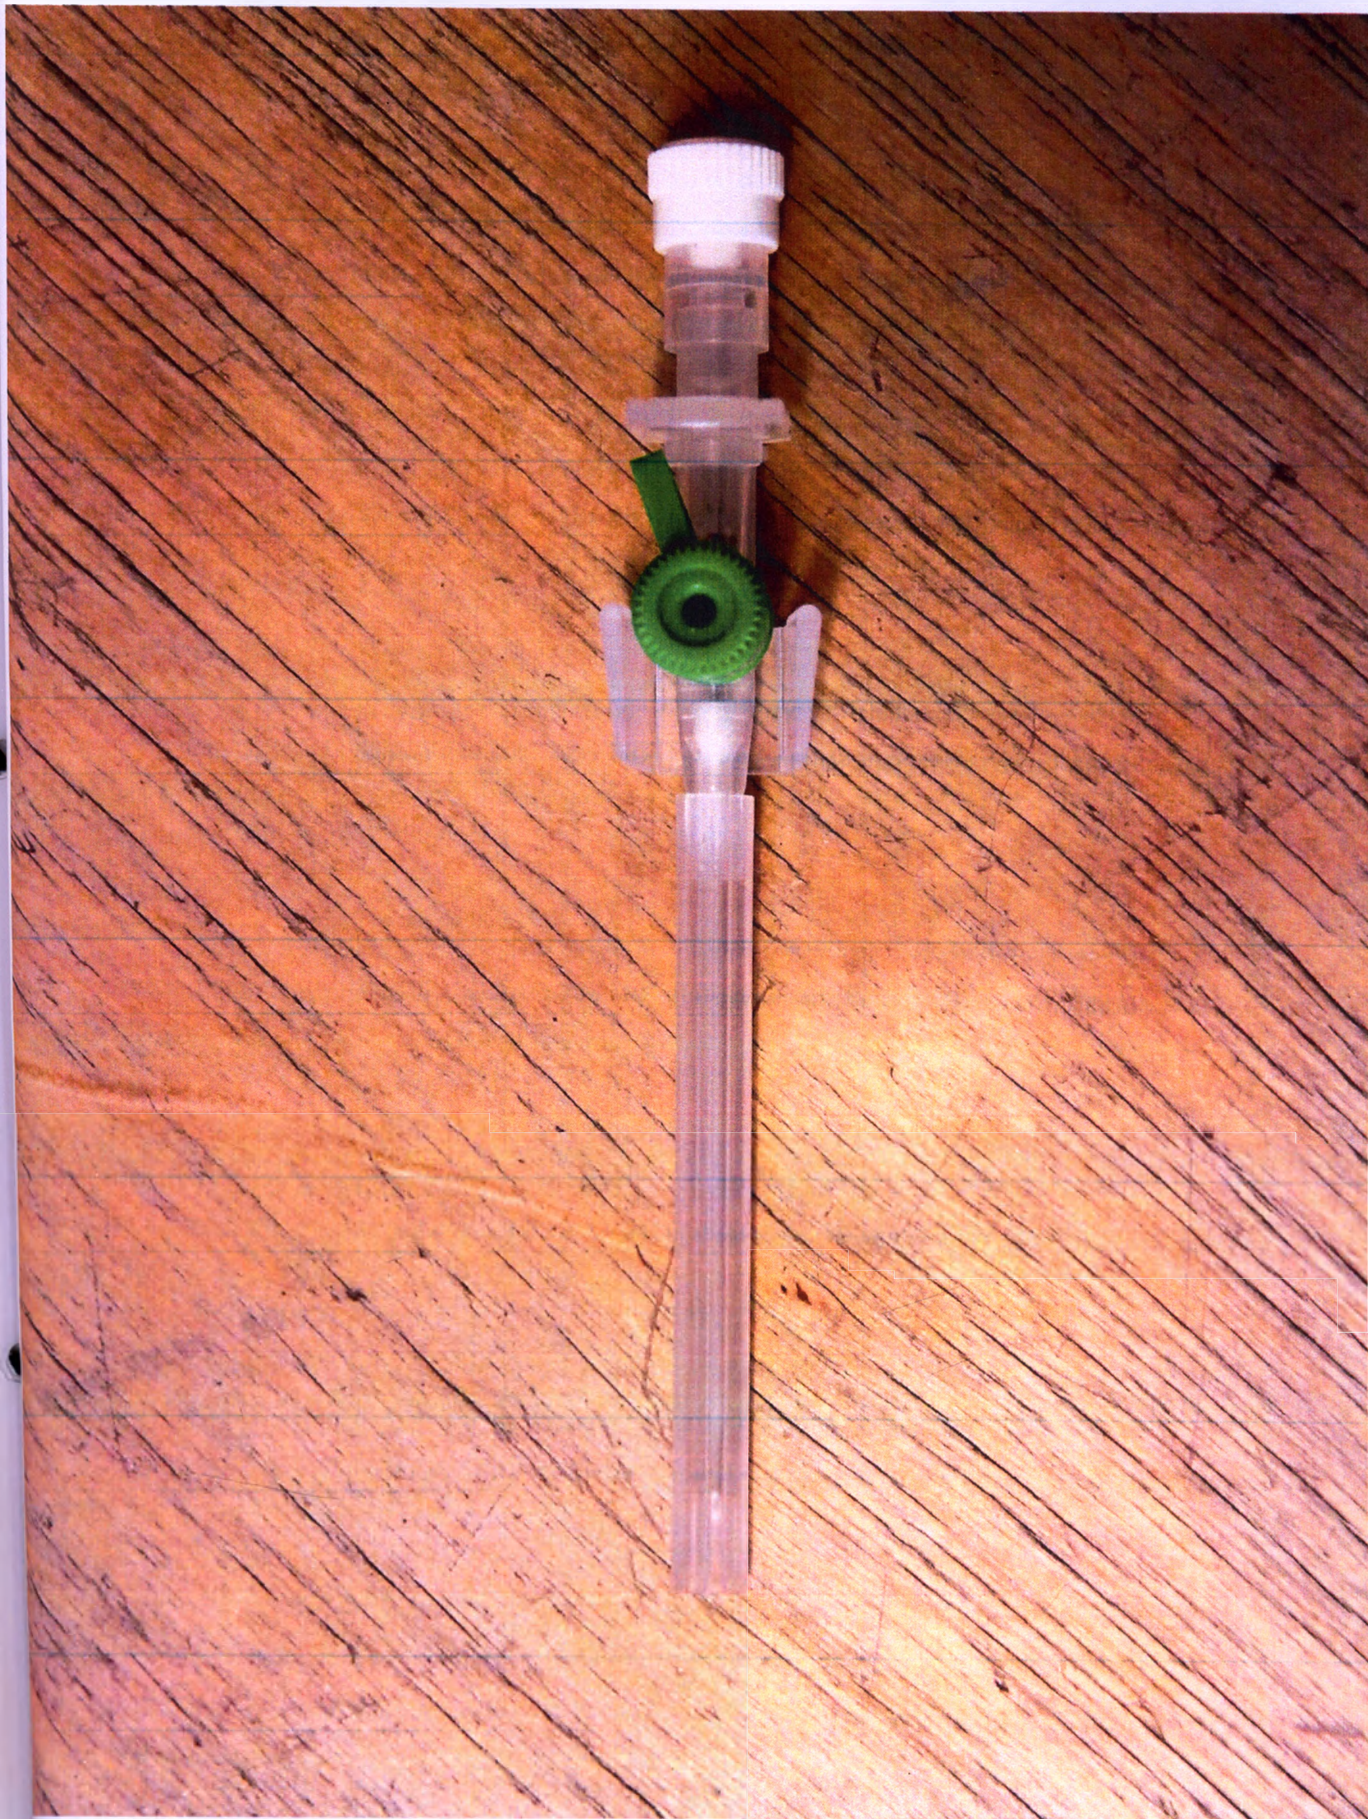

4-Катетер периферический с инъекционным портом и крыльшками 18G (Ø 1,3 мм x L 45 мм)

4-Катетер периферический с инъекционным портом и крылышками 18G (Ø 1,3 мм x L 45 мм)
(маркировка)

Angeltouch

Катетер периферический с инъекционным портом и крылышками

ОТКРЫВАТЬ ЗДЕСЬ

ЗАПРЕЩЕНО СНОВА ВВОДИТЬ В КАНОЛЮ ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО ИЗВЛЕЧЕННУЮ ПРОВОДНИКОВУЮ ИГЛУ!

1. Достать катетер из защитной упаковки. 2. Произвести венепункцию. 3. После того, как катетер будет установлен на месте должным образом, прозрачный отсек обратного оттока заполнится кровью. 4. Извлечь проводниковую иглу и подключить устройство для переливания инфузионных растворов. 5. Убедиться в правильности установки катетера. 6. Закрепить катетер полосками пластыря.

Neutral code: UK/Device/MFG/MD/2020/000008



CE
2460

ANGIPLAST PRIVATE LIMITED
Plot No. 4803, Phase IV, GIDC Vatva
Ahmedabad 382 445, India
Angioplast Private Limited, Индия
тел./факс: +91 79512011552,
e-mail: post@healthmedical.ru

РУ № ФСЗ 2012/12179 от ДДММГГГГ

Устройства однократные для переливания крови,
инфузионных растворов с принадлежностями.
Катетер периферический с
инъекционным портом и крылышками 18G

Размер (GxØxL): 18Gx1.3x45mm
Скорость потока: 90ml/min

LOT


Номер партии:



Дата изготовления:



Годен до:

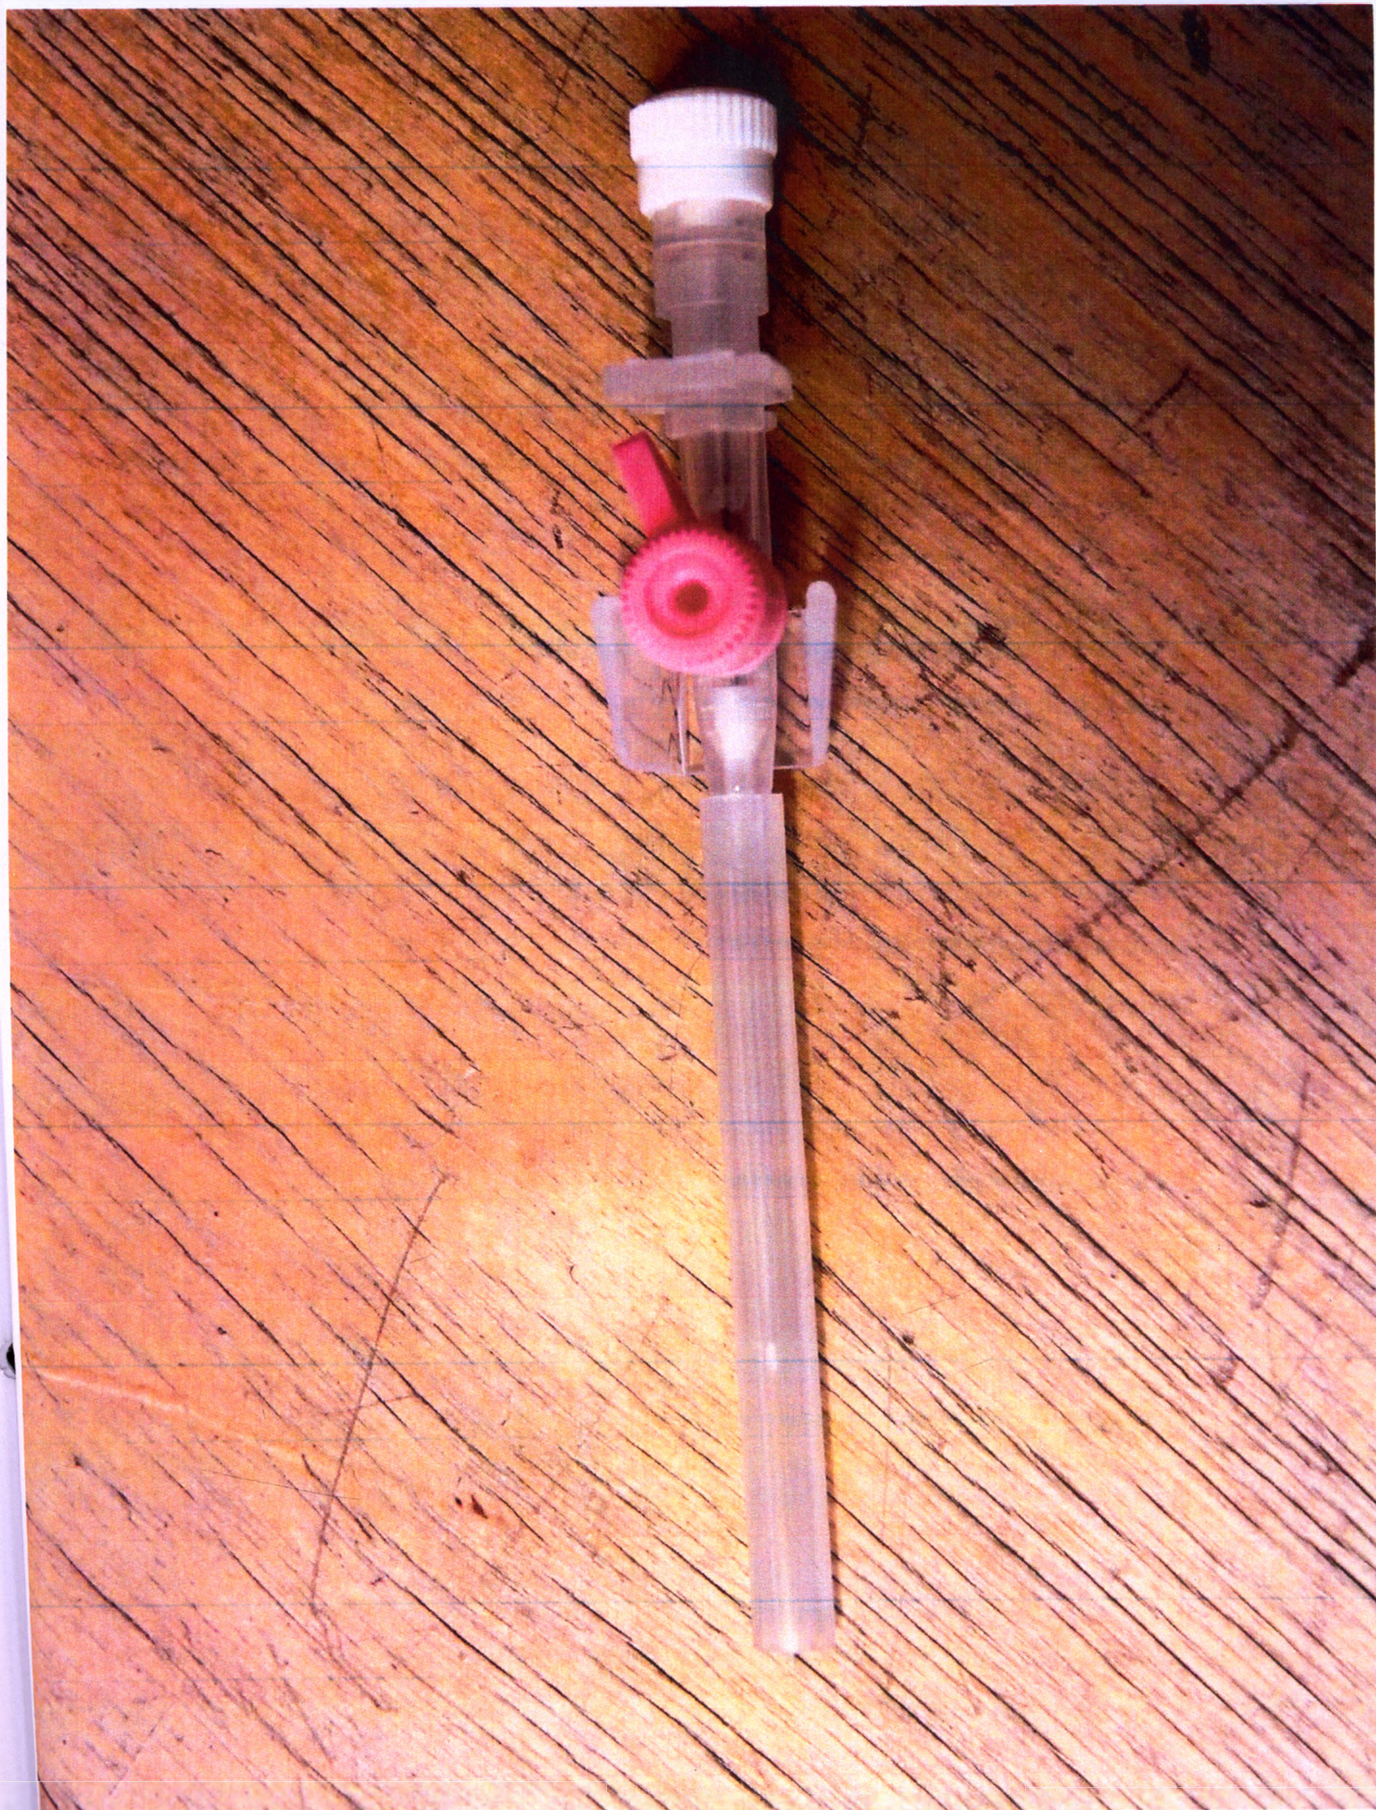

5-Катетер периферический с инъекционным портом и крыльшками 20G (Ø 1,1 мм x L 33 мм)

Катетер периферический с инъекционным портом и крылышками 20G (Ø 1,1 мм x L 33 мм)
(маркировка)

ОТКРЫВАТЬ ЗДЕСЬ

Angeltouch

Катетер периферический с инъекционным портом и крылышками

ЗАПРЕЩЕНО Снова вводить в канюлю полностью или частично извлеченную проводниковую иглу!

1. Достать катетер из защитной упаковки. 2. Произвести венепункцию. 3. После того, как катетер будет установлен на месте должным образом, прозрачный отсек обратного оттока заполнится кровью. 4. Извлечь проводниковую иглу и подключить устройство для переливания инфузионных растворов. 5. Убедиться в правильности установки катетера. 6. Закрепить катетер полосками пластыря.

Neutral code: UK/Device/MFG/MD/2020/000008



STERILE EO
Не содержит латекс

CE
2460

ANGIPLAST PRIVATE LIMITED
Plot No. 4803, Phase IV, GIDC Vatva,
Ahmedabad 382 445 India
Angioplast Private Limited Индия
тел./факс: +91 79 512043552,
e-mail: post@healthmedical.ru

РУ № ФСЗ 2012/12179 от ДДММГГГГ

Устройства одноразовые для переливания крови,
инфузионных растворов с принадлежностями
Катетер периферический с
инъекционным портом и крылышками. 20G

Размер (GxØxL): 20Gx1.1x33mm
Скорость потока: 60ml/min

LOT


Номер партии:



Дата изготовления:



Годен до:

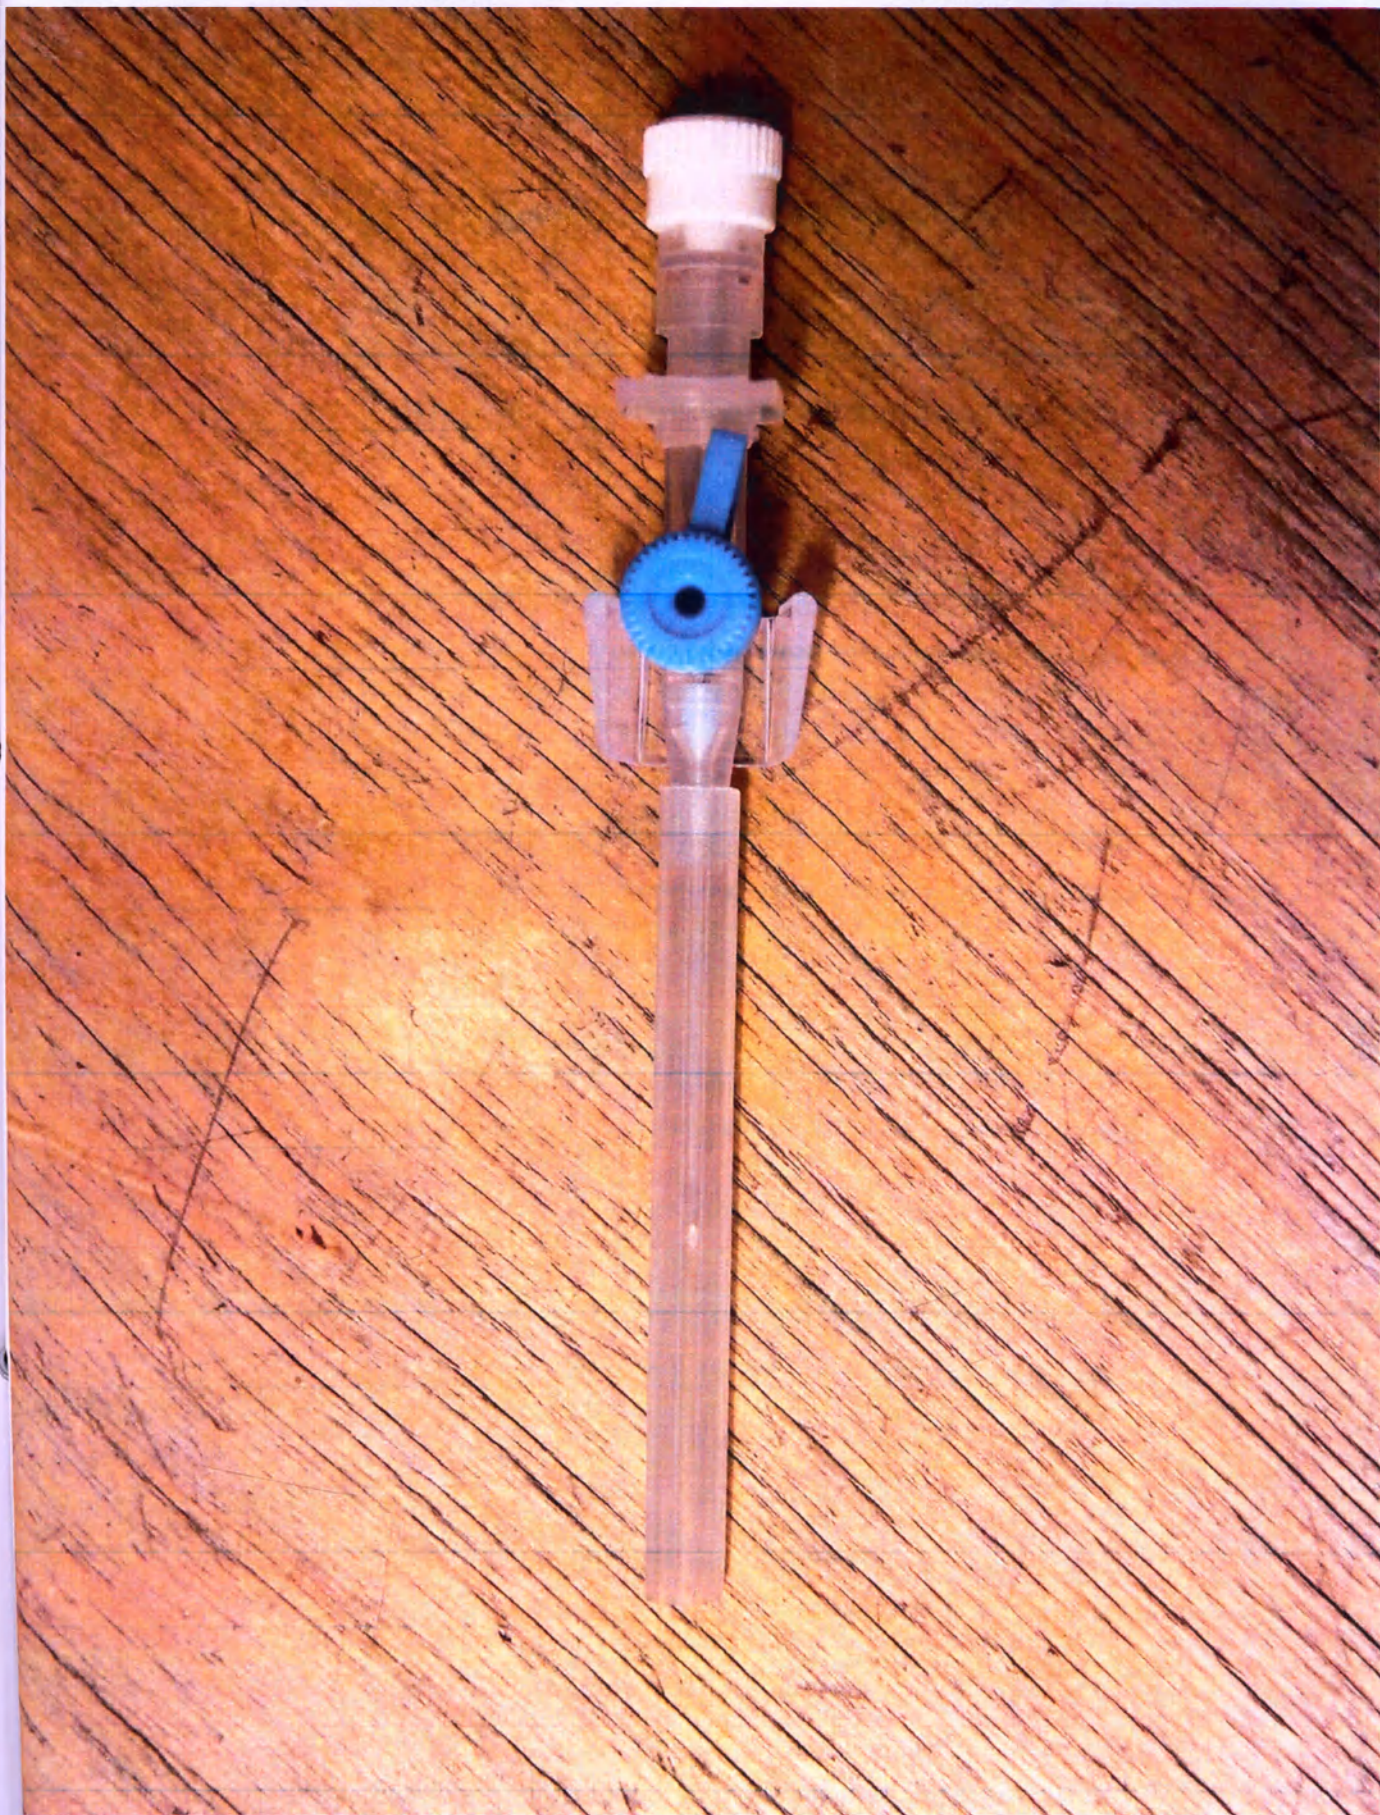

6-Катетер периферический с инъекционным портом и крыльшками 22G (Ø 0,9 мм x L 25 мм)

Катетер периферический с инъекционным портом и крылышками 22G (Ø 0,9 мм x L 25 мм)
(маркировка)

ОТКРЫВАТЬ ЗДЕСЬ

Angeltouch

Катетер периферический с инъекционным портом и крылышками

ЗАПРЕЩЕНО СНОВА ВВОДИТЬ В КАНЮЛЮ ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО ИЗВЛЕЧЕННУЮ ПРОВОДНИКОВУЮ ИГЛУ!

1. Достать катетер из защитной упаковки. 2. Произвести венепункцию. 3. После того, как катетер будет установлен на месте должным образом, прозрачный отсек обратного оттока заполнится кровью. 4. Извлечь проводниковую иглу и подключить устройство для переливания инфузионных растворов. 5. Убедиться в правильности установки катетера. 6. Закрепить катетер полосками пластыря.

Neutral code: UK/Device/MFG/MD/2020/000008



STERILE EO
Не содержит латекс

CE
2460

ANGIPLAST PRIVATE LIMITED
Plot No. 4803, Phase IV, GIDC Vatva,
Ahmedabad 382 445 India
Angioplast Private Limited, Индия
тел./факс: +91 49512043552
e-mail: post@healthmedical.ru

РУ № ФСЗ 2012/12179 от ДДММГГГГ

Устройства одноразовые для переливания крови,
инфузионных растворов с принадлежностями.
Катетер периферический с
инъекционным портом и крылышками 22G

Размер (GxØxL): 22Gx0.9x25mm
Скорость потока: 36ml/min




Номер партии:



Дата изготовления:



Годен до:

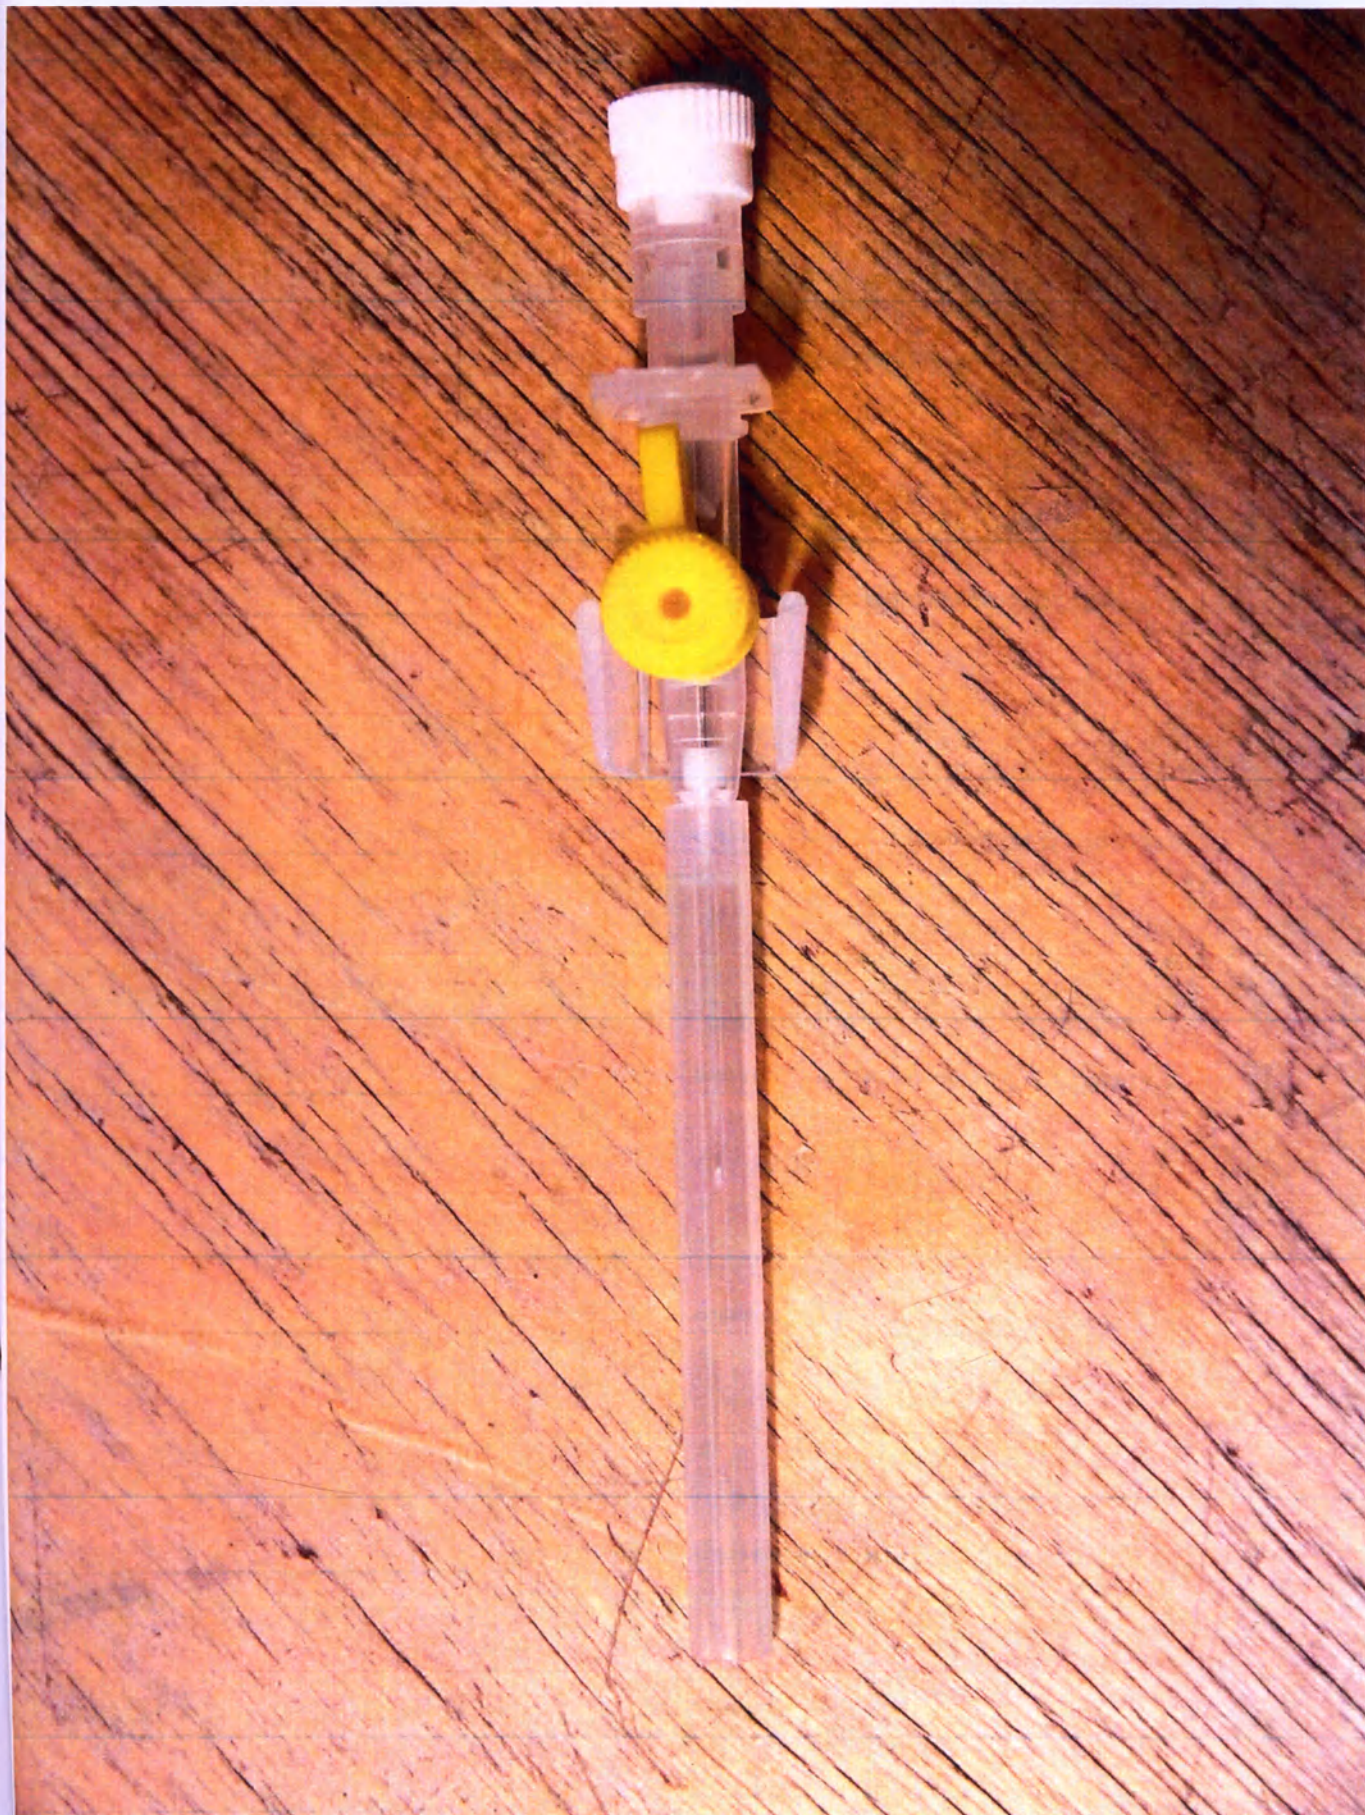

7-Катетер периферический с инъекционным портом и крыльшками 24G (Ø 0,7 мм x L 19 мм)

17-Катетер периферический с инъекционным портом и крылышками 24G (Ø 0,7 мм x L 19 мм)
(маркировка)

ОТКРЫВАТЬ ЗДЕСЬ

Angeltouch

Катетер периферический с инъекционным портом и крылышками

ЗАПРЕЩЕНО СНОВА ВВОДИТЬ В КАНЮЛЮ ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО ИЗВЛЕЧЕННУЮ ПРОВОДНИКОВУЮ ИГЛУ!

1. Достать катетер из защитной упаковки. 2. Произвести венепункцию. 3. После того, как катетер будет установлен на месте должным образом, прозрачный отсек обратного оттока заполнится кровью. 4. Извлечь проводниковую иглу и подключить устройство для переливания инфузионных растворов. 5. Убедиться в правильности установки катетера. 6. Закрепить катетер полосками пластыря.

Neutral code: UK/Device/MFG/MD/2020/000008



Не содержит латекс

CE
2460

ANGIPLAST PRIVATE LIMITED
Plot No. 4803, Phase IV, GIDC Vatva,
Ahmedabad 382 445 India
Angioplast Private Limited Индия
тел. факс: +91 (495) 2043552
e-mail: post@healthmedical.ru

РУ № ФСЗ 2012/12179 от ДДММГГГГ

Устройства одноразовые для переливания крови
инфузионных растворов с принадлежностями
Катетер периферический с
инъекционным портом и крылышками 24G

Размер (GxØxL): 24Gx0.70x19mm


Скорость потока: 23ml/min

LOT

Номер партии:

Дата изготовления:

Годен до:

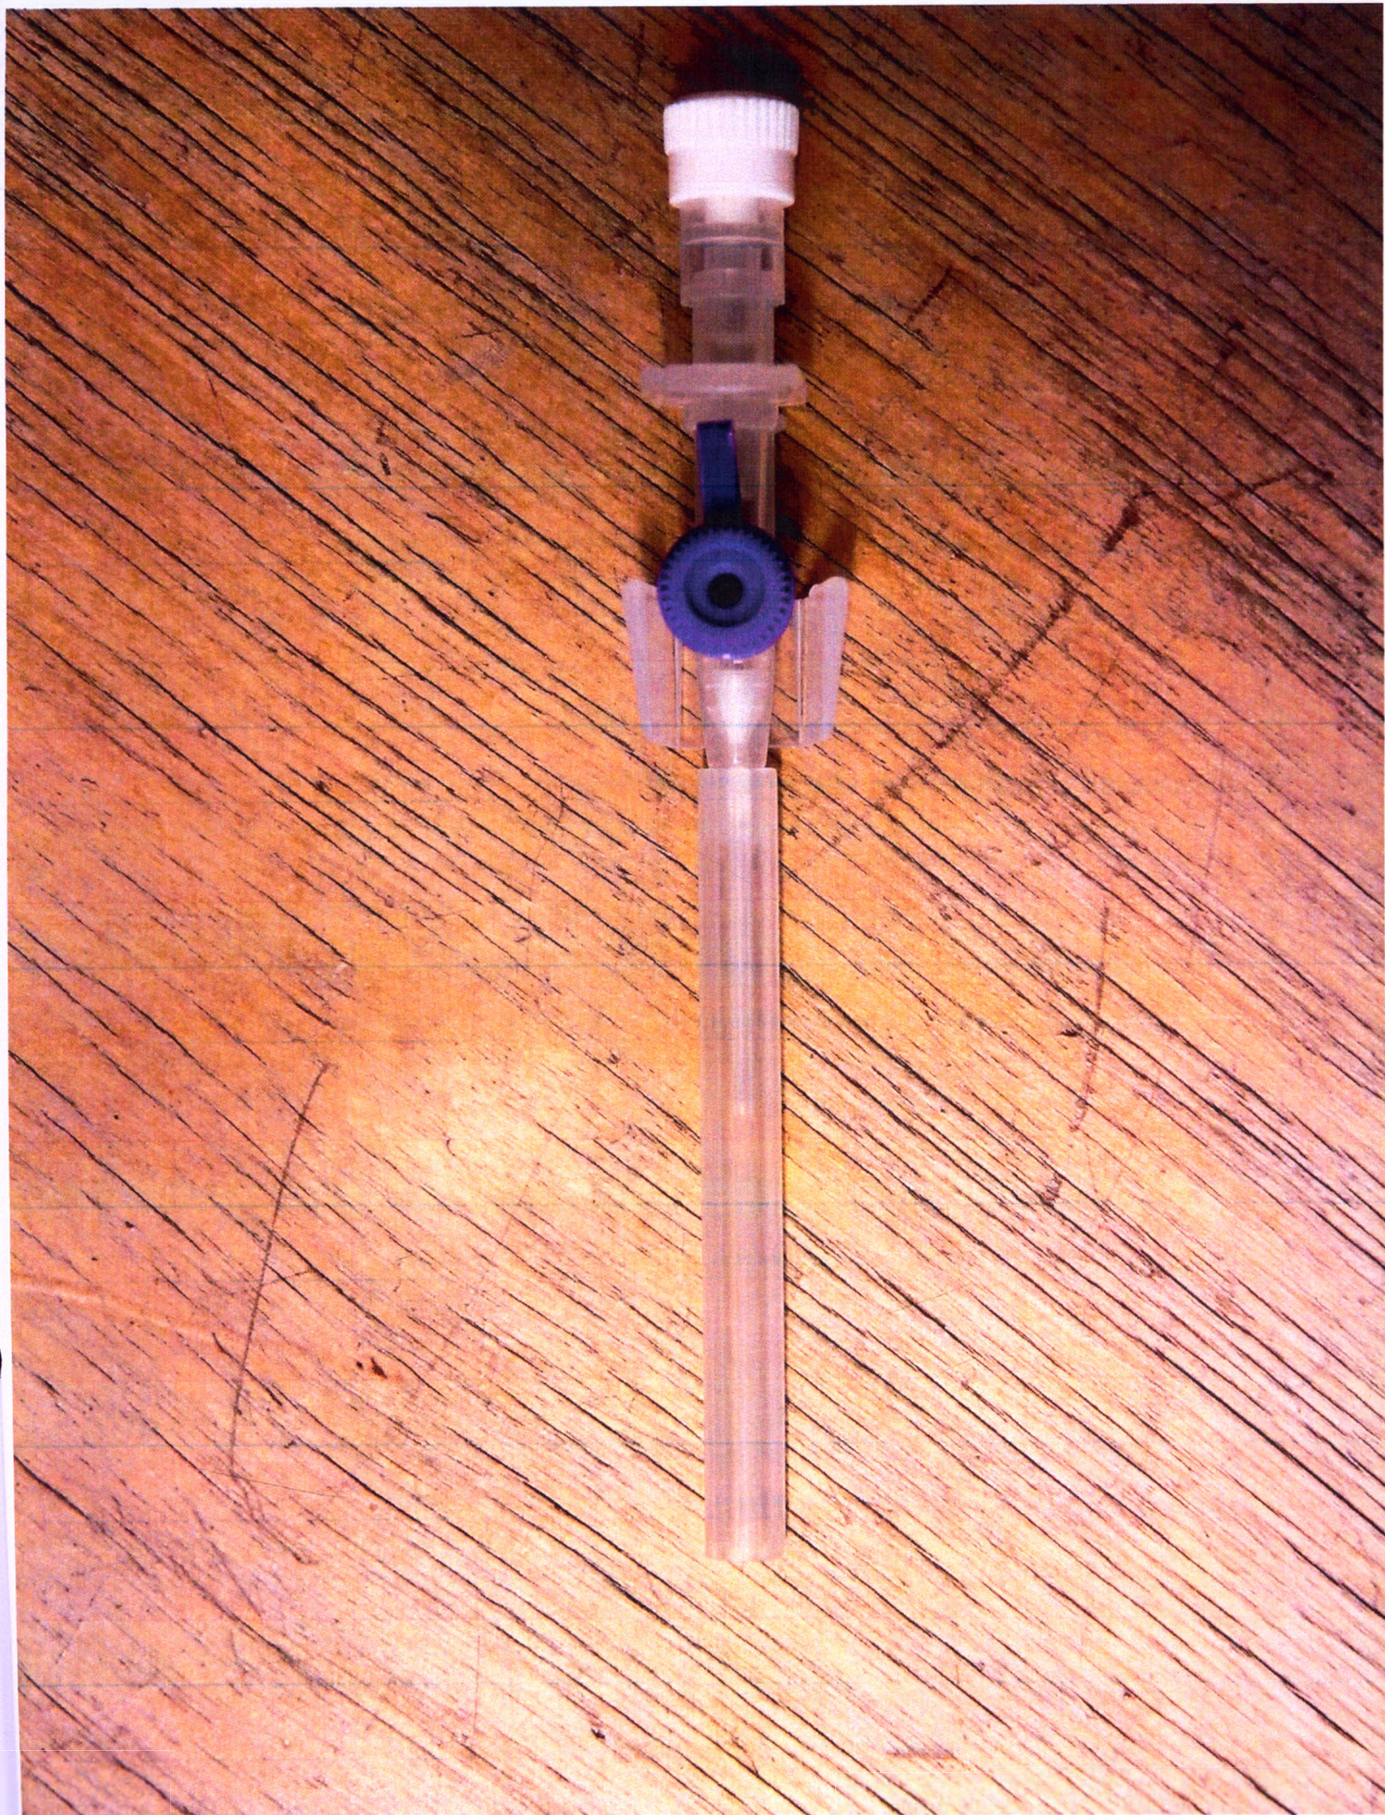

1.8-Катетер периферический с инъекционным портом и крылышками 26G (Ø 0,6 мм x L 19 мм)

1-8-Катетер периферический с инъекционным портом и крылышками 26G (Ø 0,6 мм x L 19 мм)
(маркировка)

ОТКРЫВАТЬ ЗДЕСЬ

Angeltouch

Катетер периферический с инъекционным портом и крылышками

ЗАПРЕЩЕНО СНОВА ВВОДИТЬ В КАНЮЛЮ ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО ИЗВЛЕЧЕННУЮ ПРОВОДНИКОВУЮ ИГЛУ!

1. Достать катетер из защитной упаковки. 2. Произвести венепункцию. 3. После того, как катетер будет установлен на месте должным образом, прозрачный отсек обратного оттока заполнится кровью. 4. Извлечь проводниковую иглу и подключить устройство для переливания инфузионных растворов. 5. Убедиться в правильности установки катетера. 6. Закрепить катетер полосками пластыря.

Neutral code:UK/Device/MFG/MD/2020/000008



STERILE EO
Не содержит латекс

CE
2460

ANGIPLAST PRIVATE LIMITED
Plot No. 4803, Phase IV, GIDC, Valva,
Ahmedabad 382 445 India
Angioplast Private Limited Индия
тел./факс: +7(495)2041352
e-mail: prosteticheskimed.ru

РУ № ФСЗ 2012/12179 от ДДММГГГГ

Устройства одноразовые для переливания крови,
инфузионных растворов с принадлежностями

Катетер периферический с
инъекционным портом и крылышками 26G

Размер (GxØxL): 26Gx0.6x19mm

Скорость
потока: 15ml/min

LOT


Номер
партии:

Дата
изготовления:

Годен до:



2-Кран трехходовый 76 мм (в упаковке)

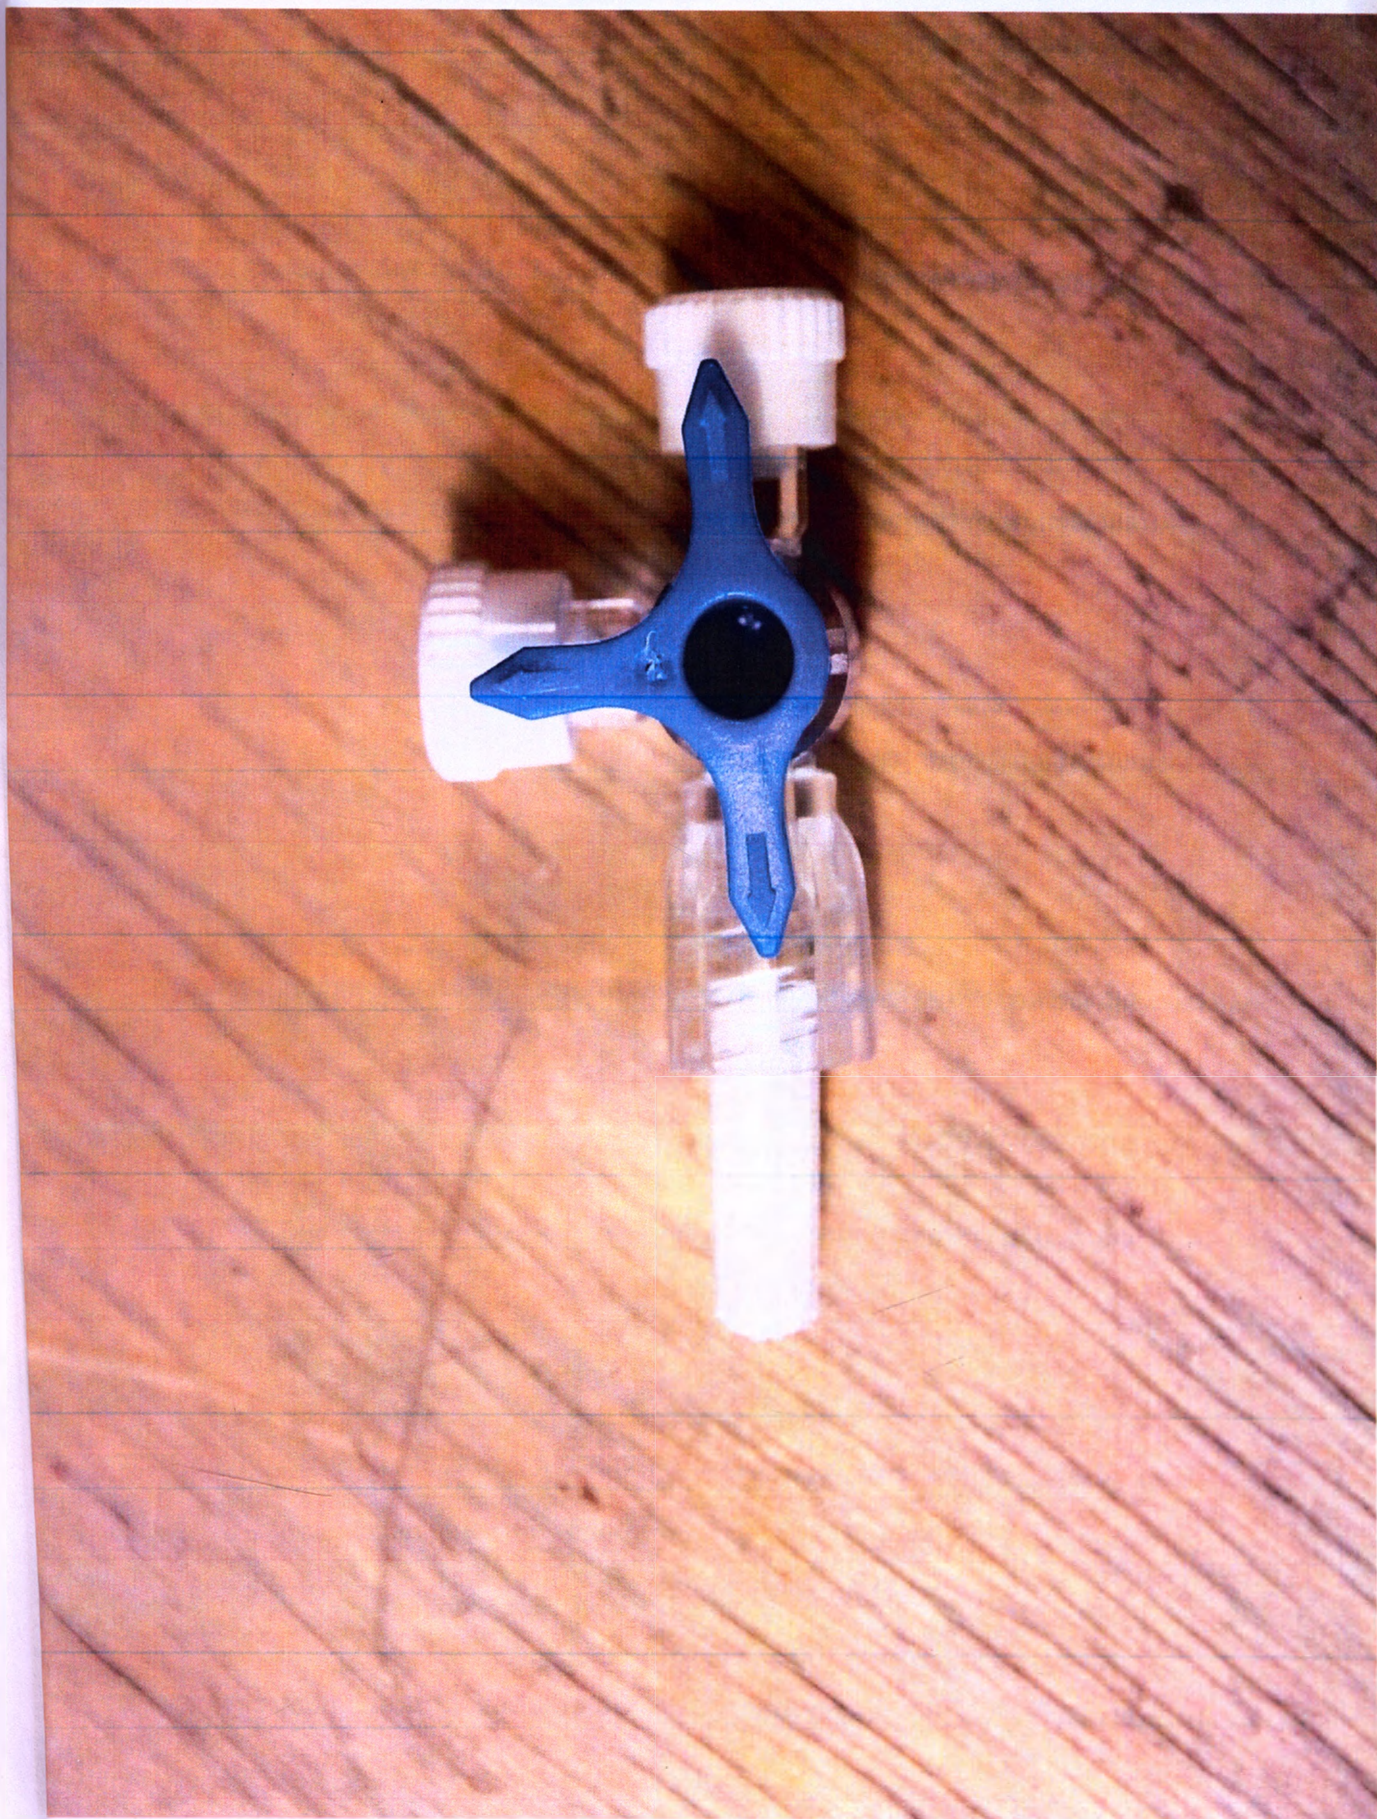

2-Кран трехходовый 76 мм

Всего пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью
50 листа (ов)