



Фотографические изображения
медицинского изделия

***Система однофотонной эмиссионной компьютер-
ной томографии (ОФЭКТ) с принадлежностями,
варианты исполнения Discovery NM 630, NM 830***


УТВЕРЖДАЮ

Руководитель отдела

регистрации и сертификации


Россия и СНГ ООО «ДжиИ Хэлскеа»

«ДжиИ Хэлскеа»
LLC GE Healthcare
для документов


 А.П. Харитоновна



18 » 05 2022г.

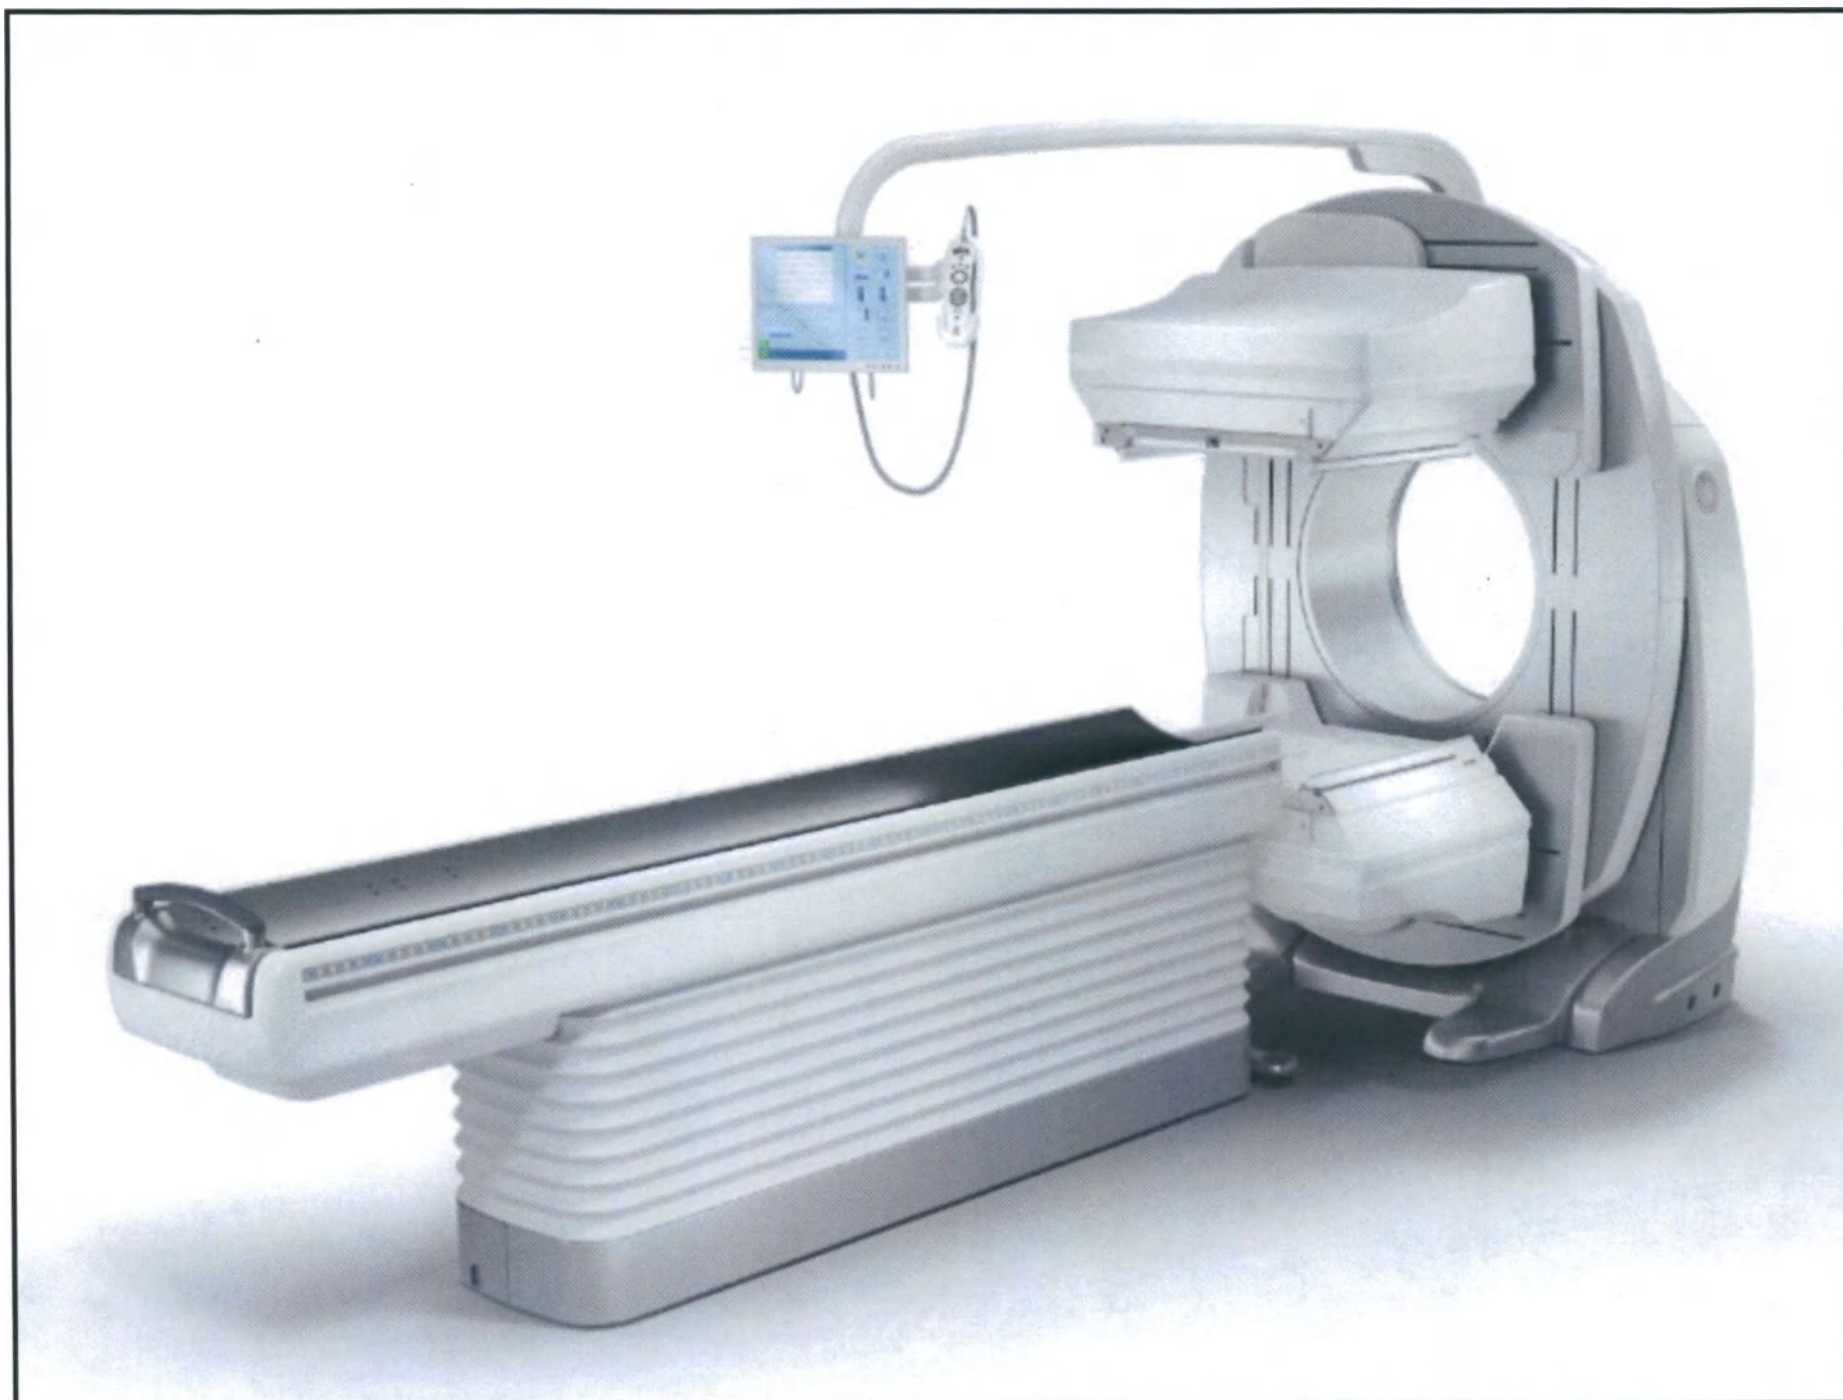


Пример макета маркировки на русском языке

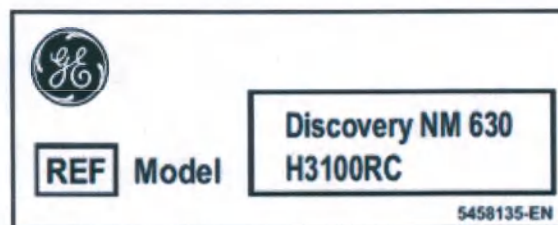


Общий Вид




Пример макета маркировки на русском языке

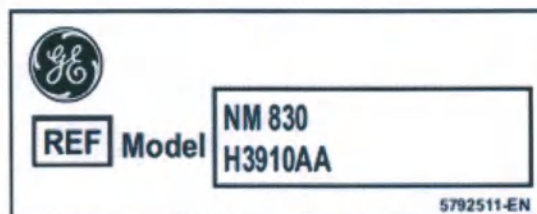



1. Система однофотонной эмиссионной компьютерной томографии (ОФЭКТ), вариант исполнения Discovery NM 630: Гентри.

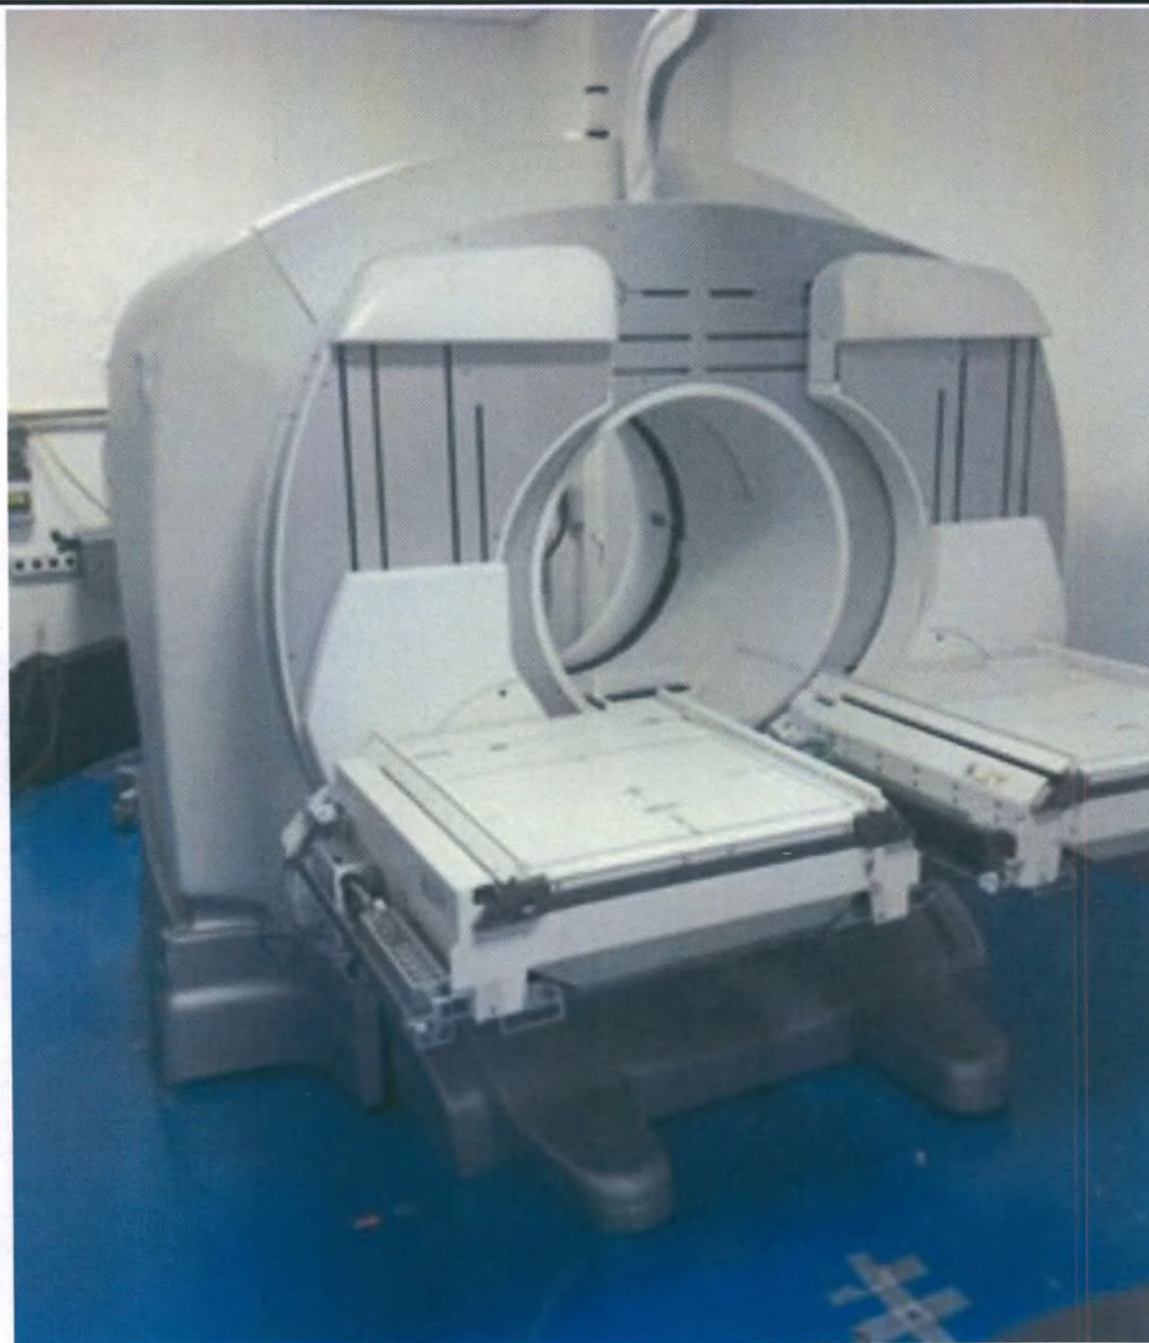

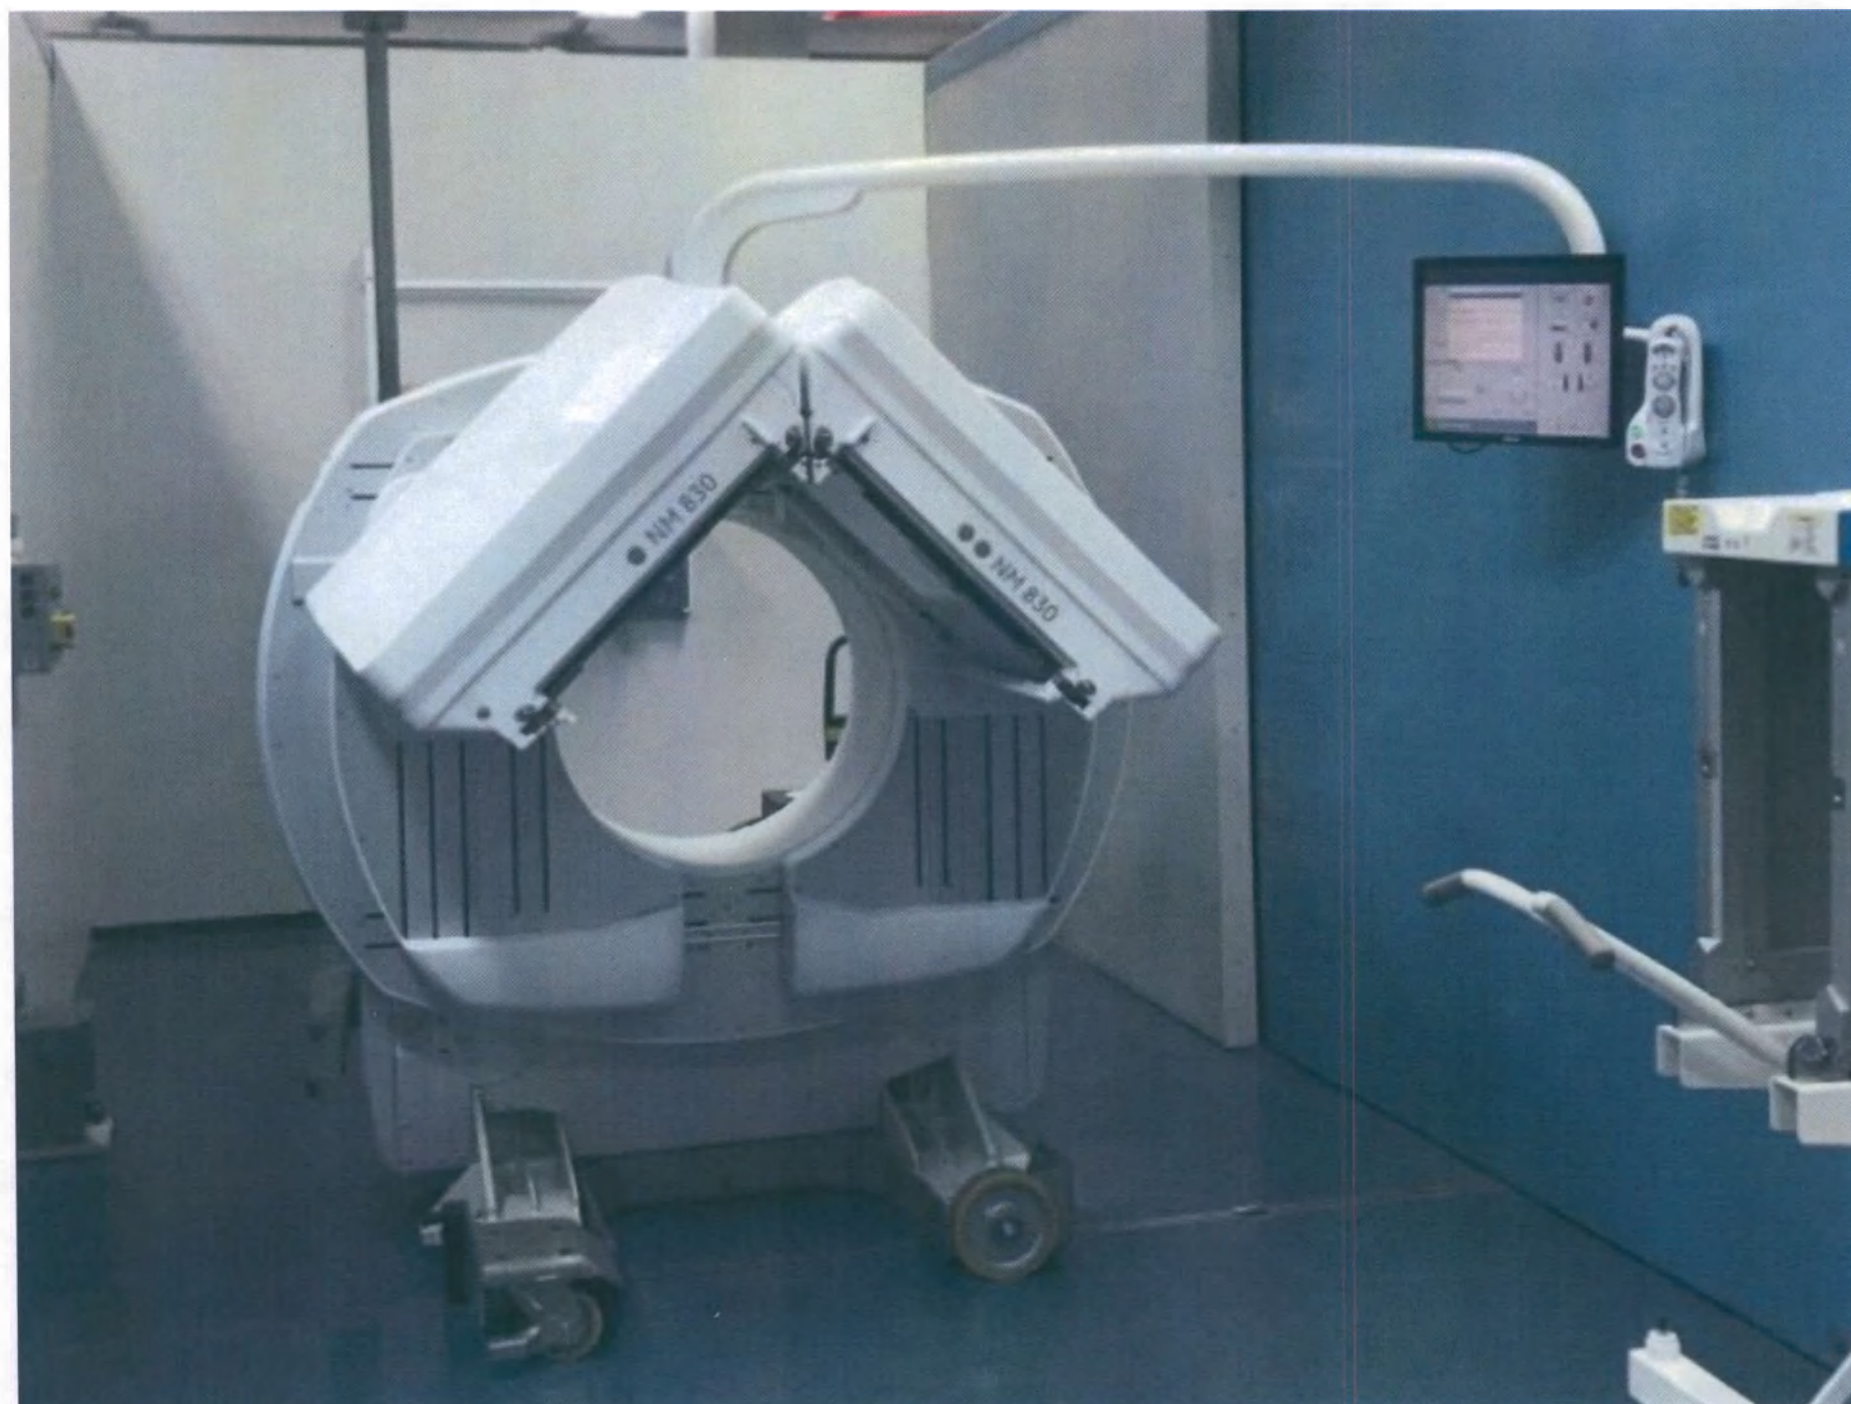



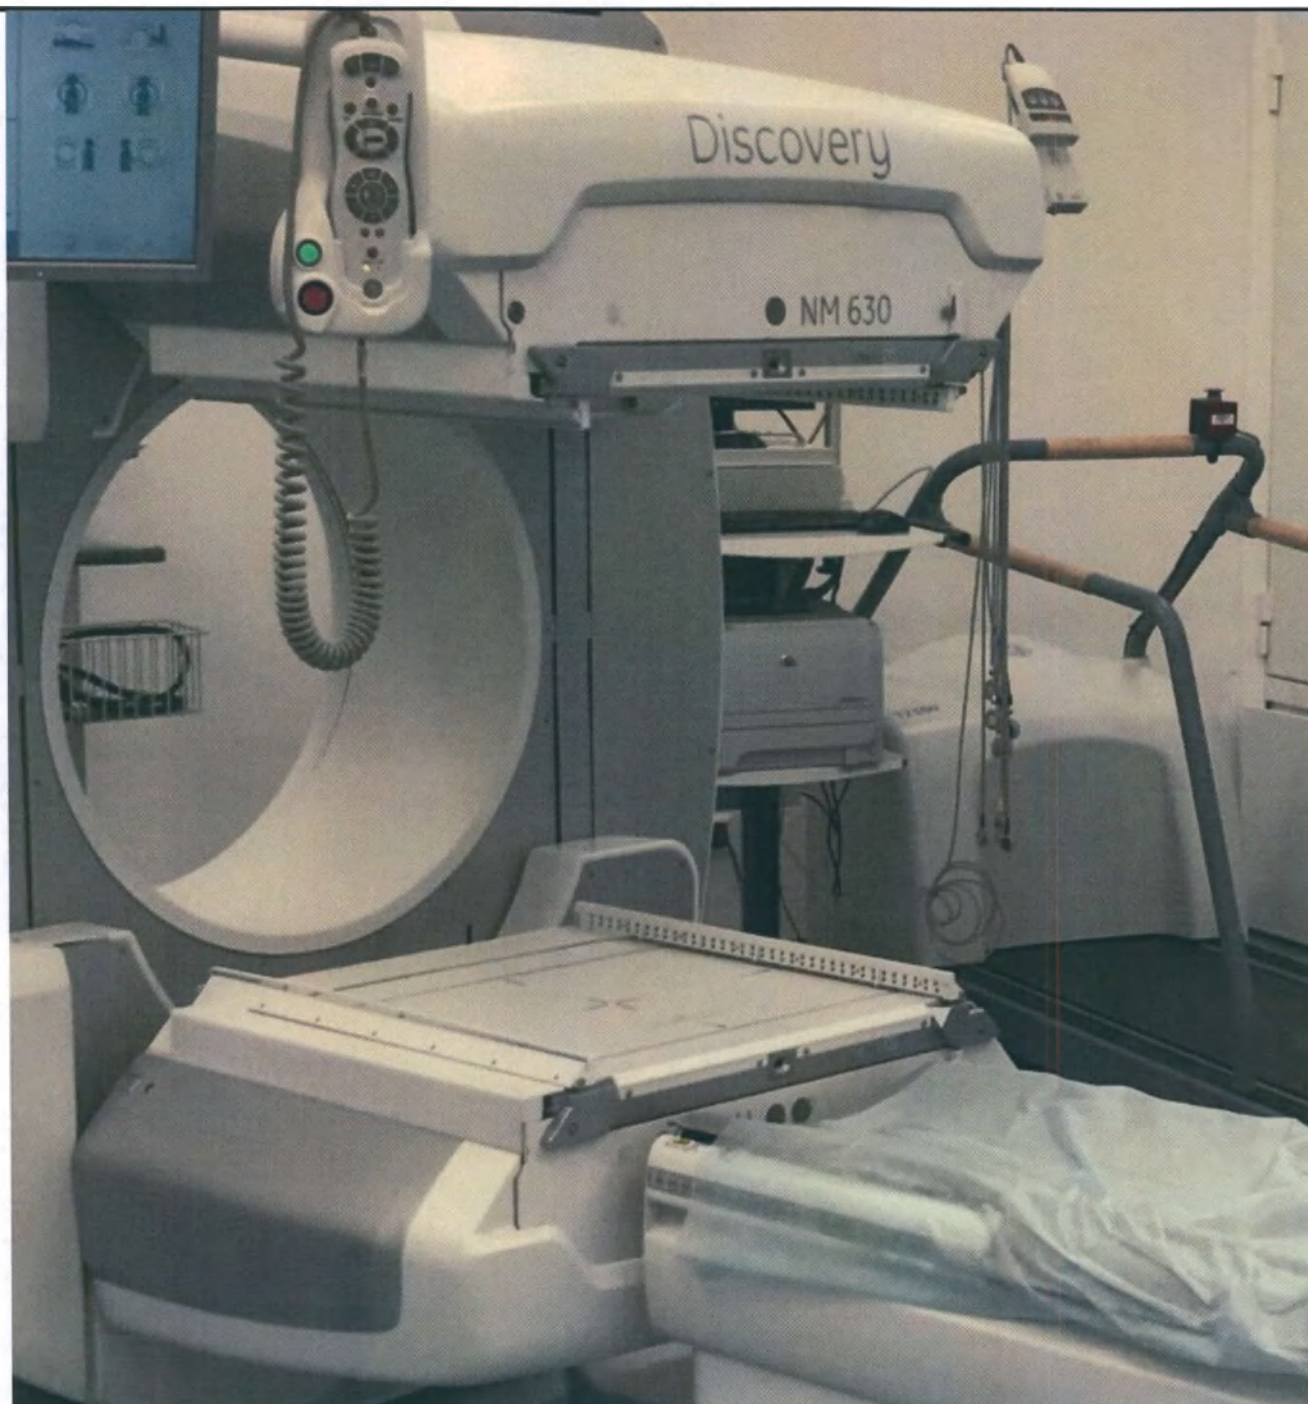

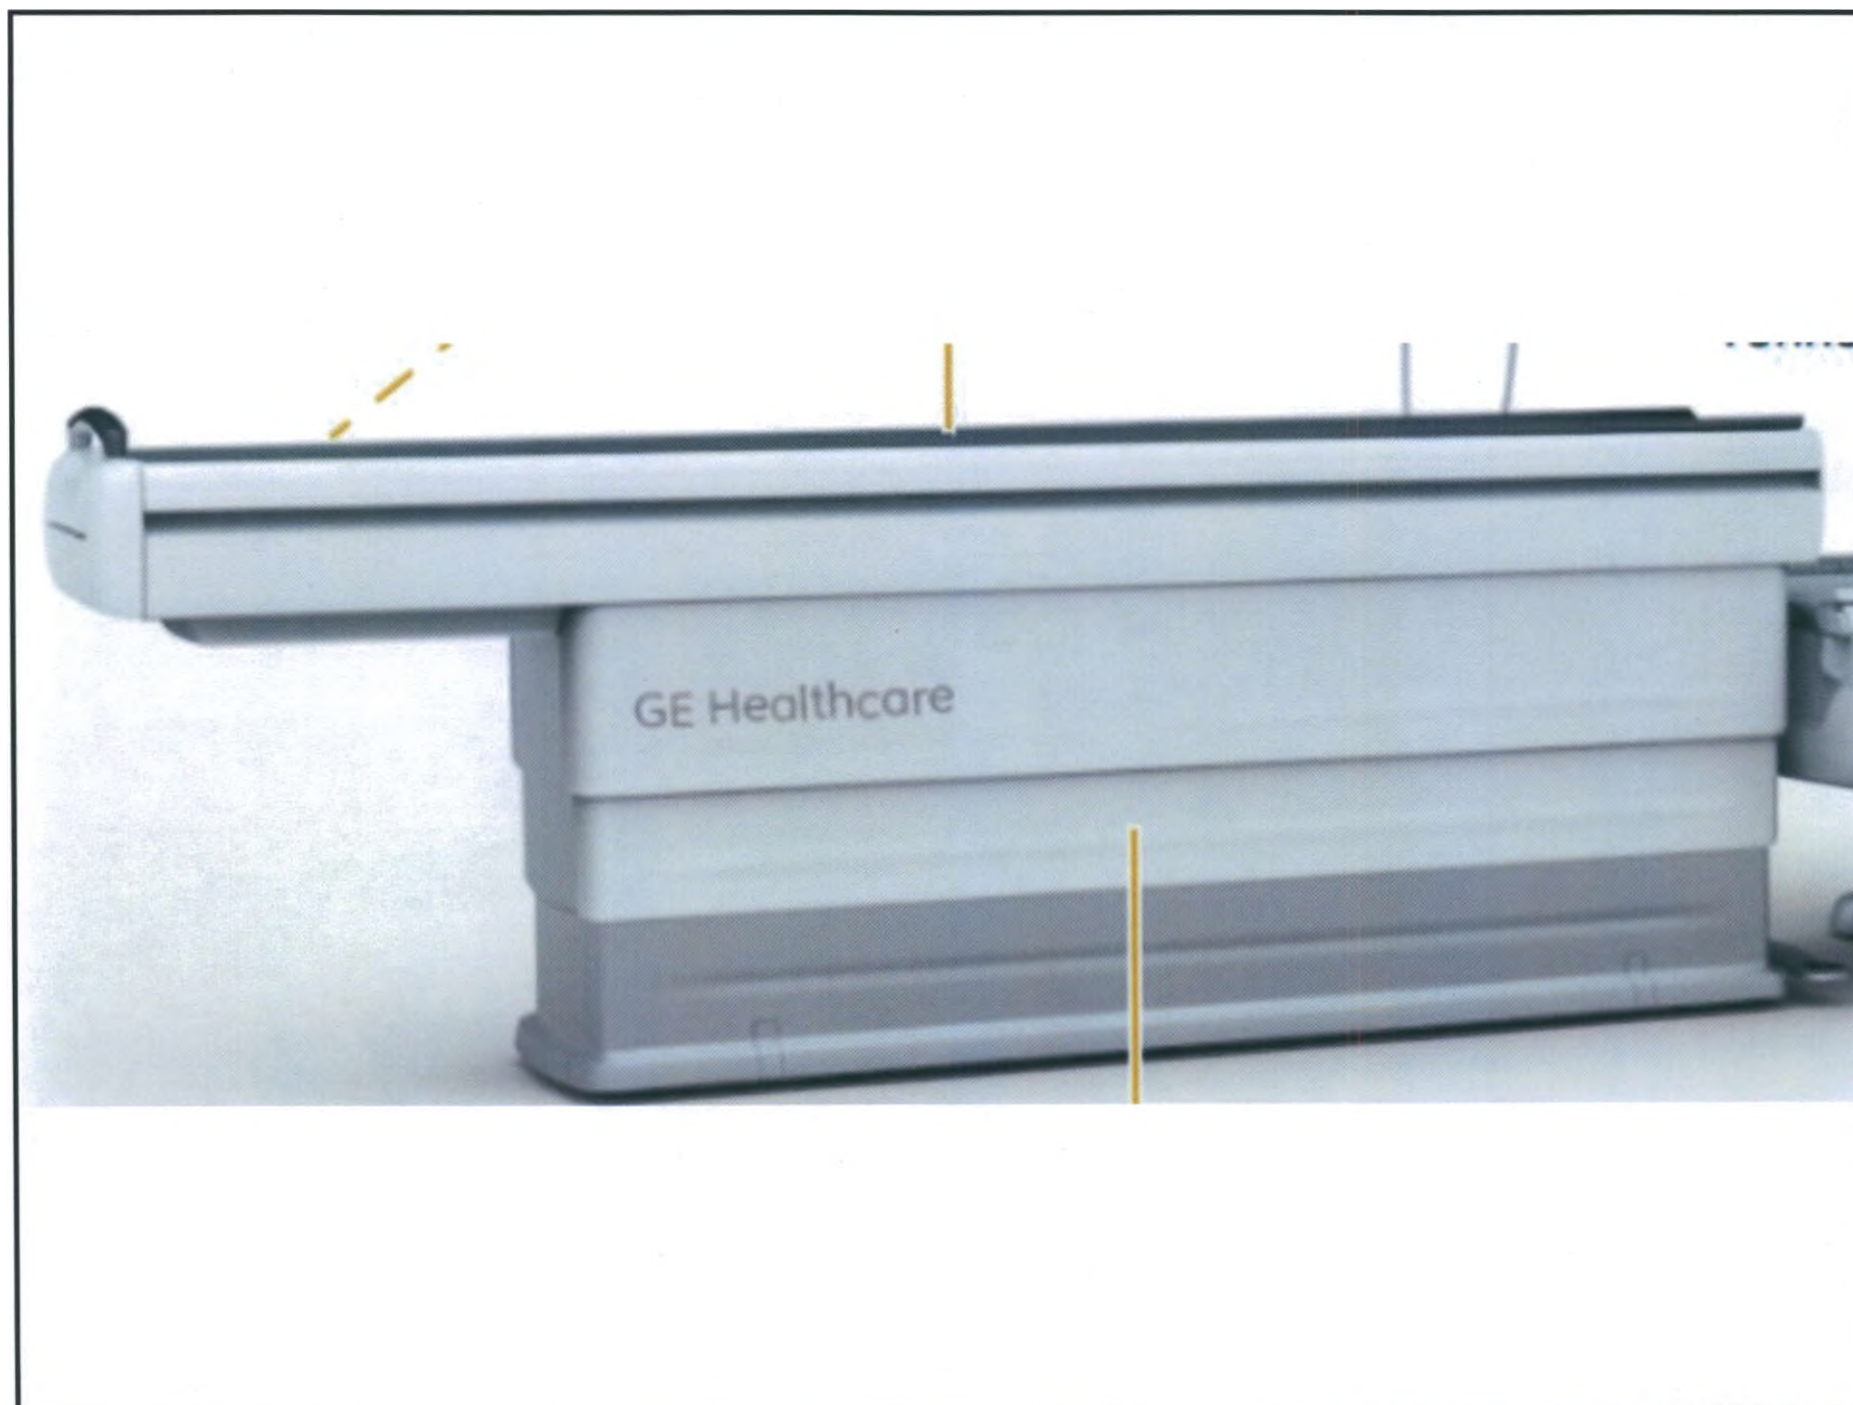








Технические издания

Документ 5788186-1RU

Ред. 3

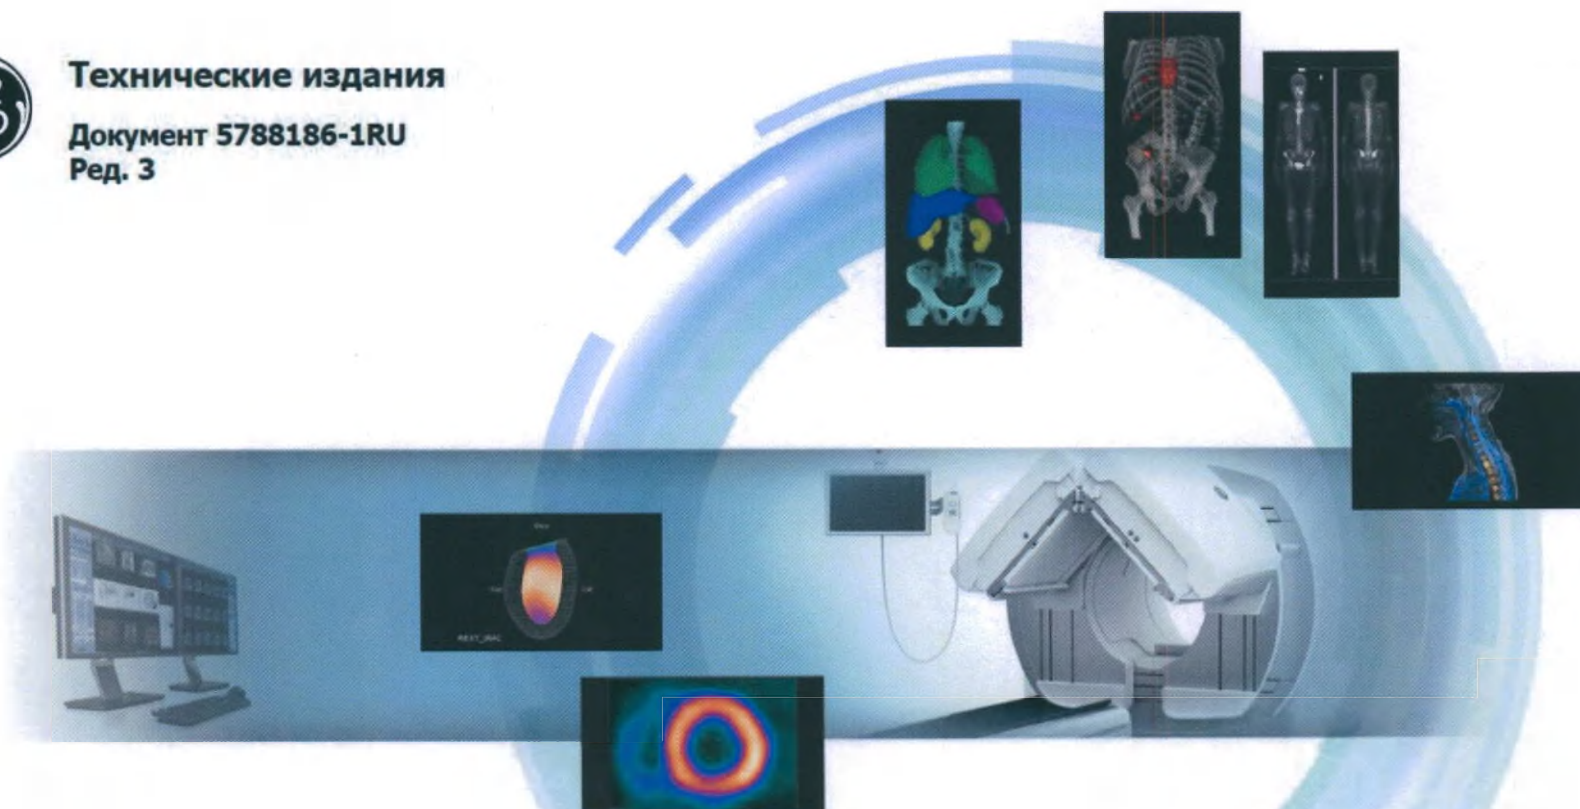

Системы серий NM800 и NM600

Системы визуализации для исследований в области ядерной медицины

Описание системы и руководство по технике безопасности для операторов

© 2020 GE














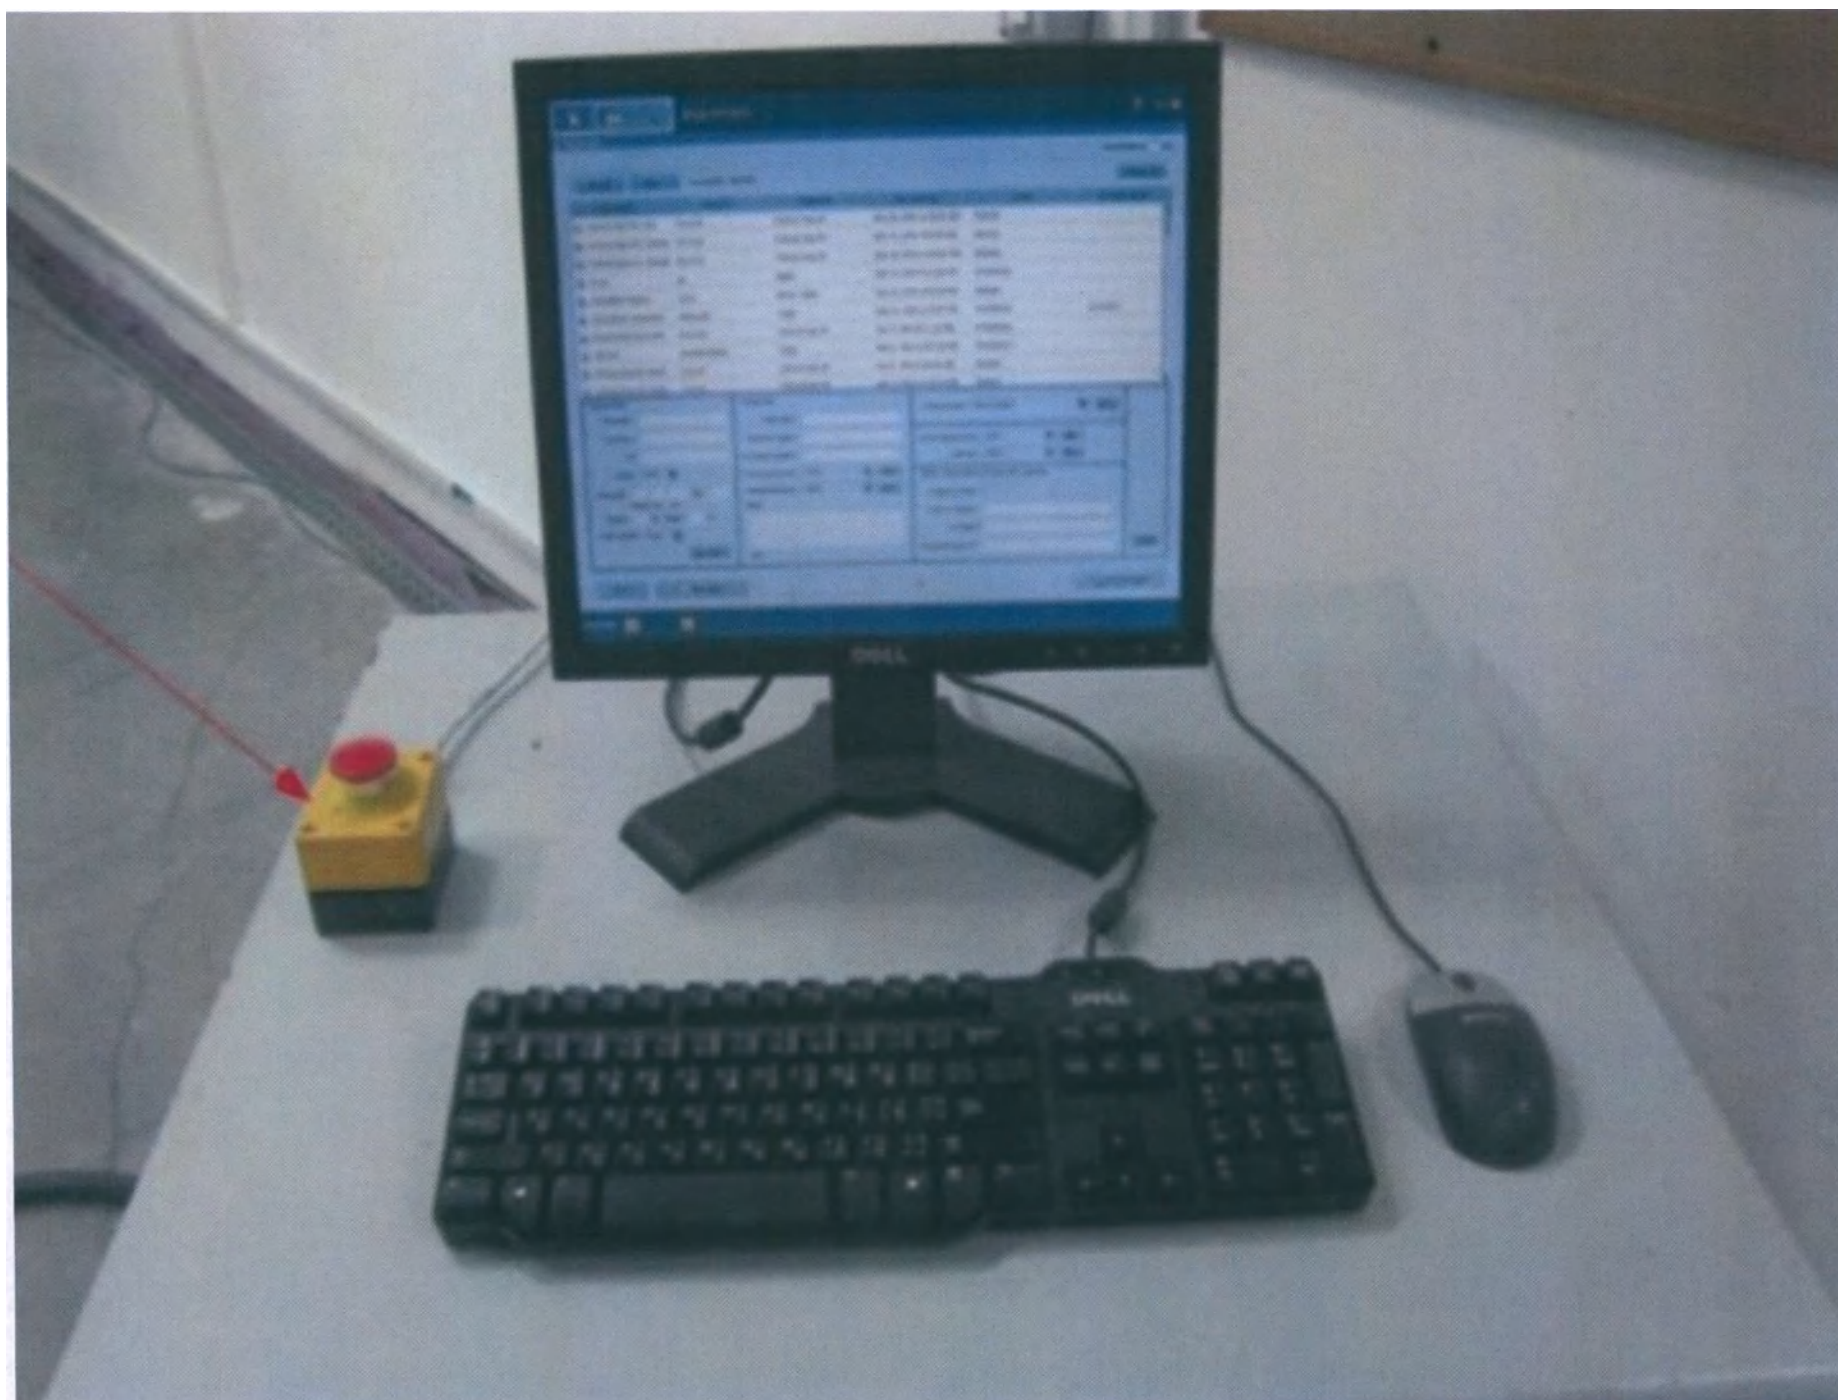




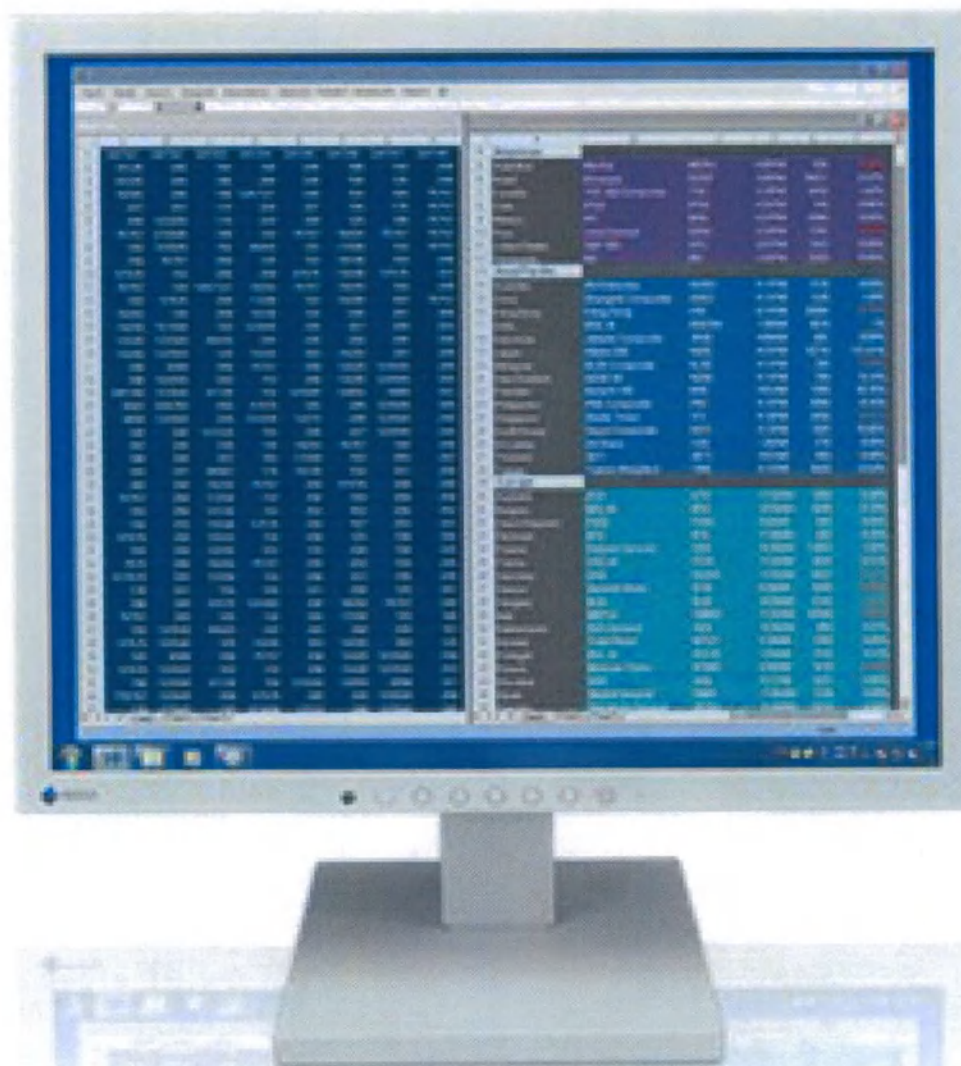

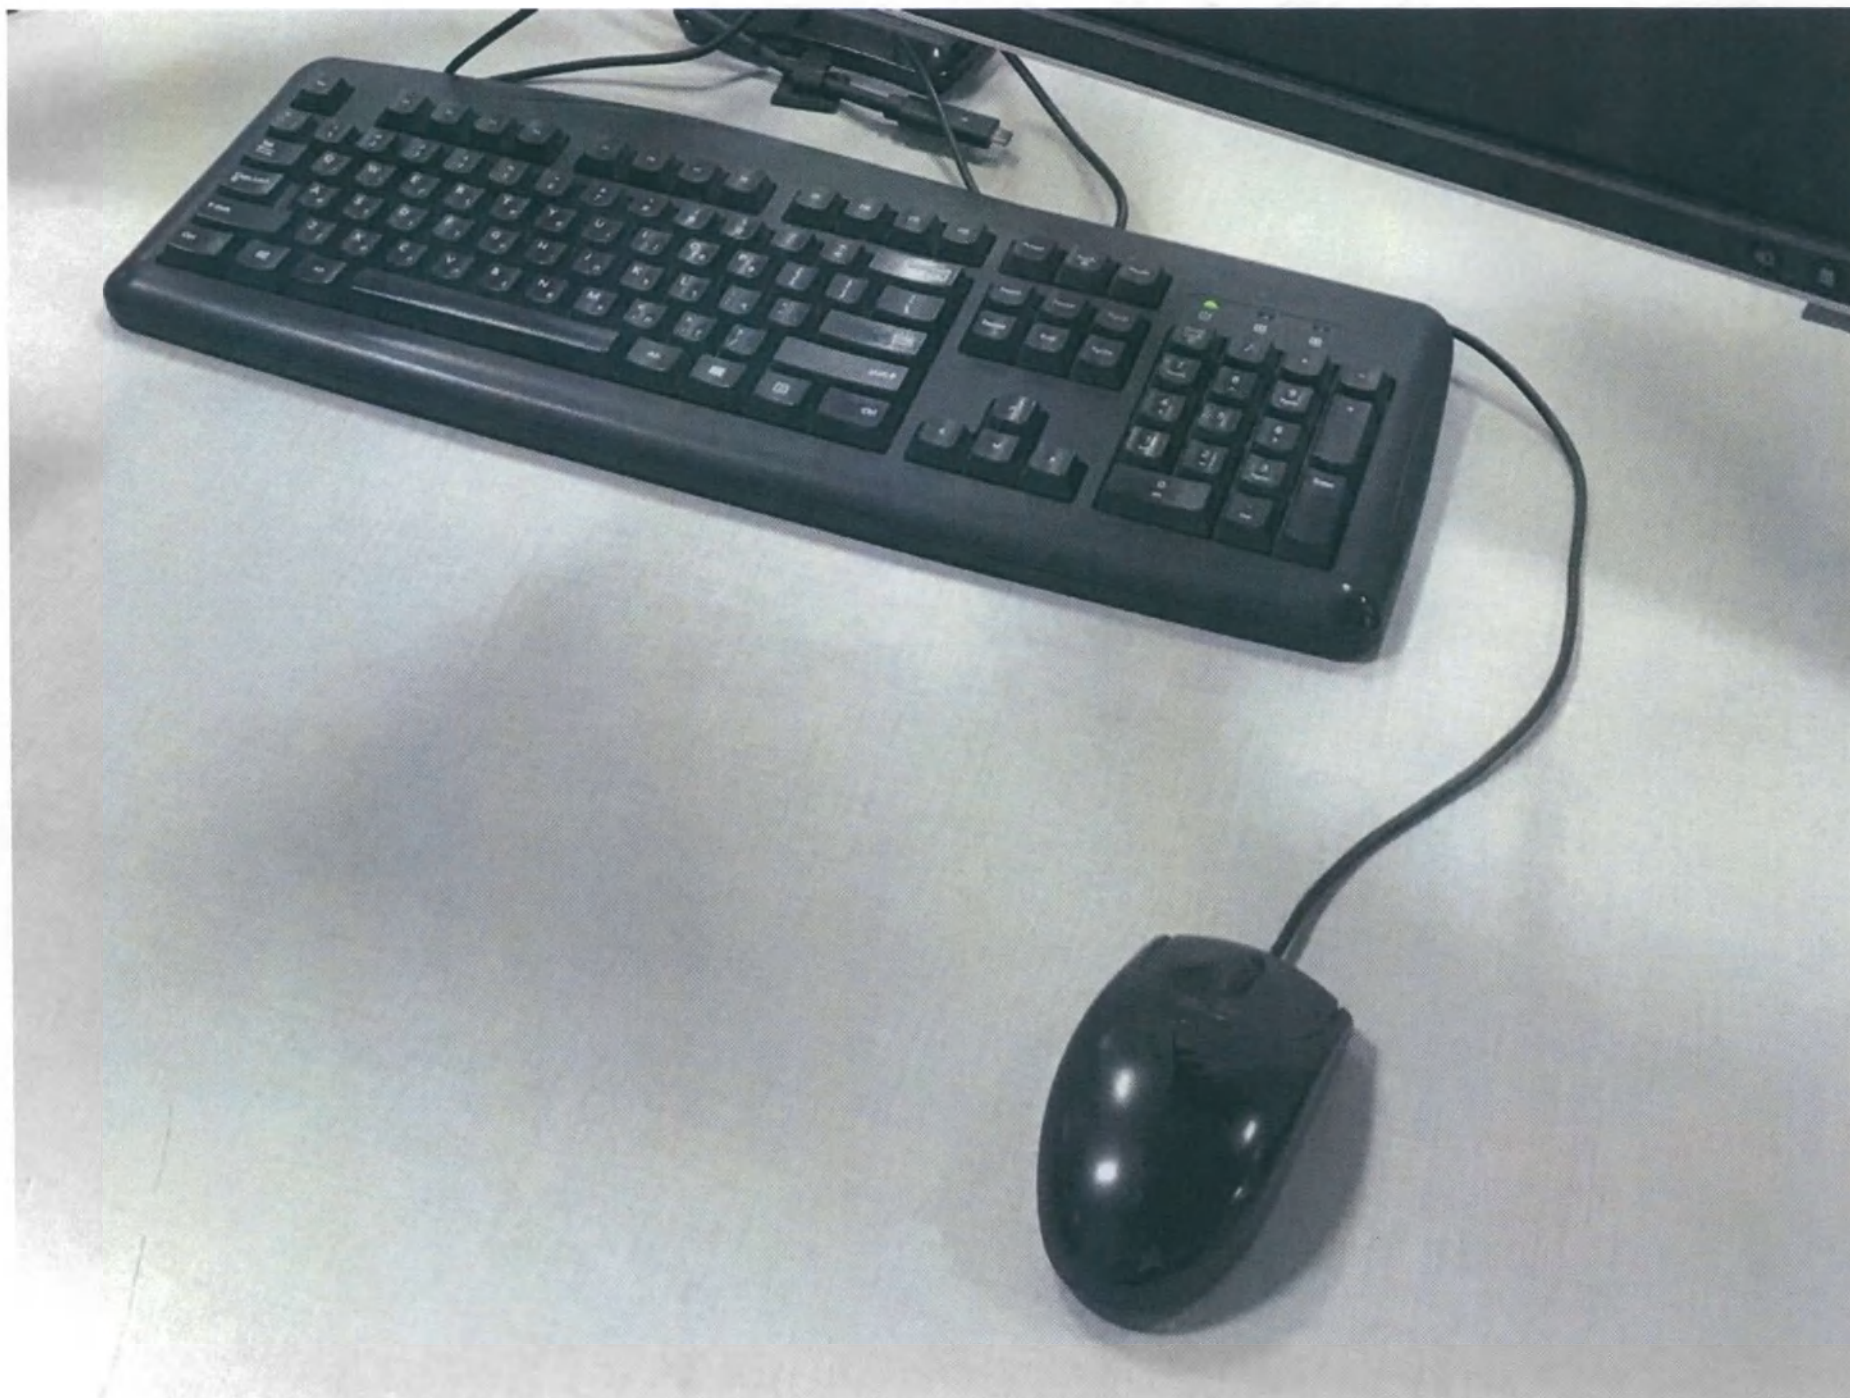






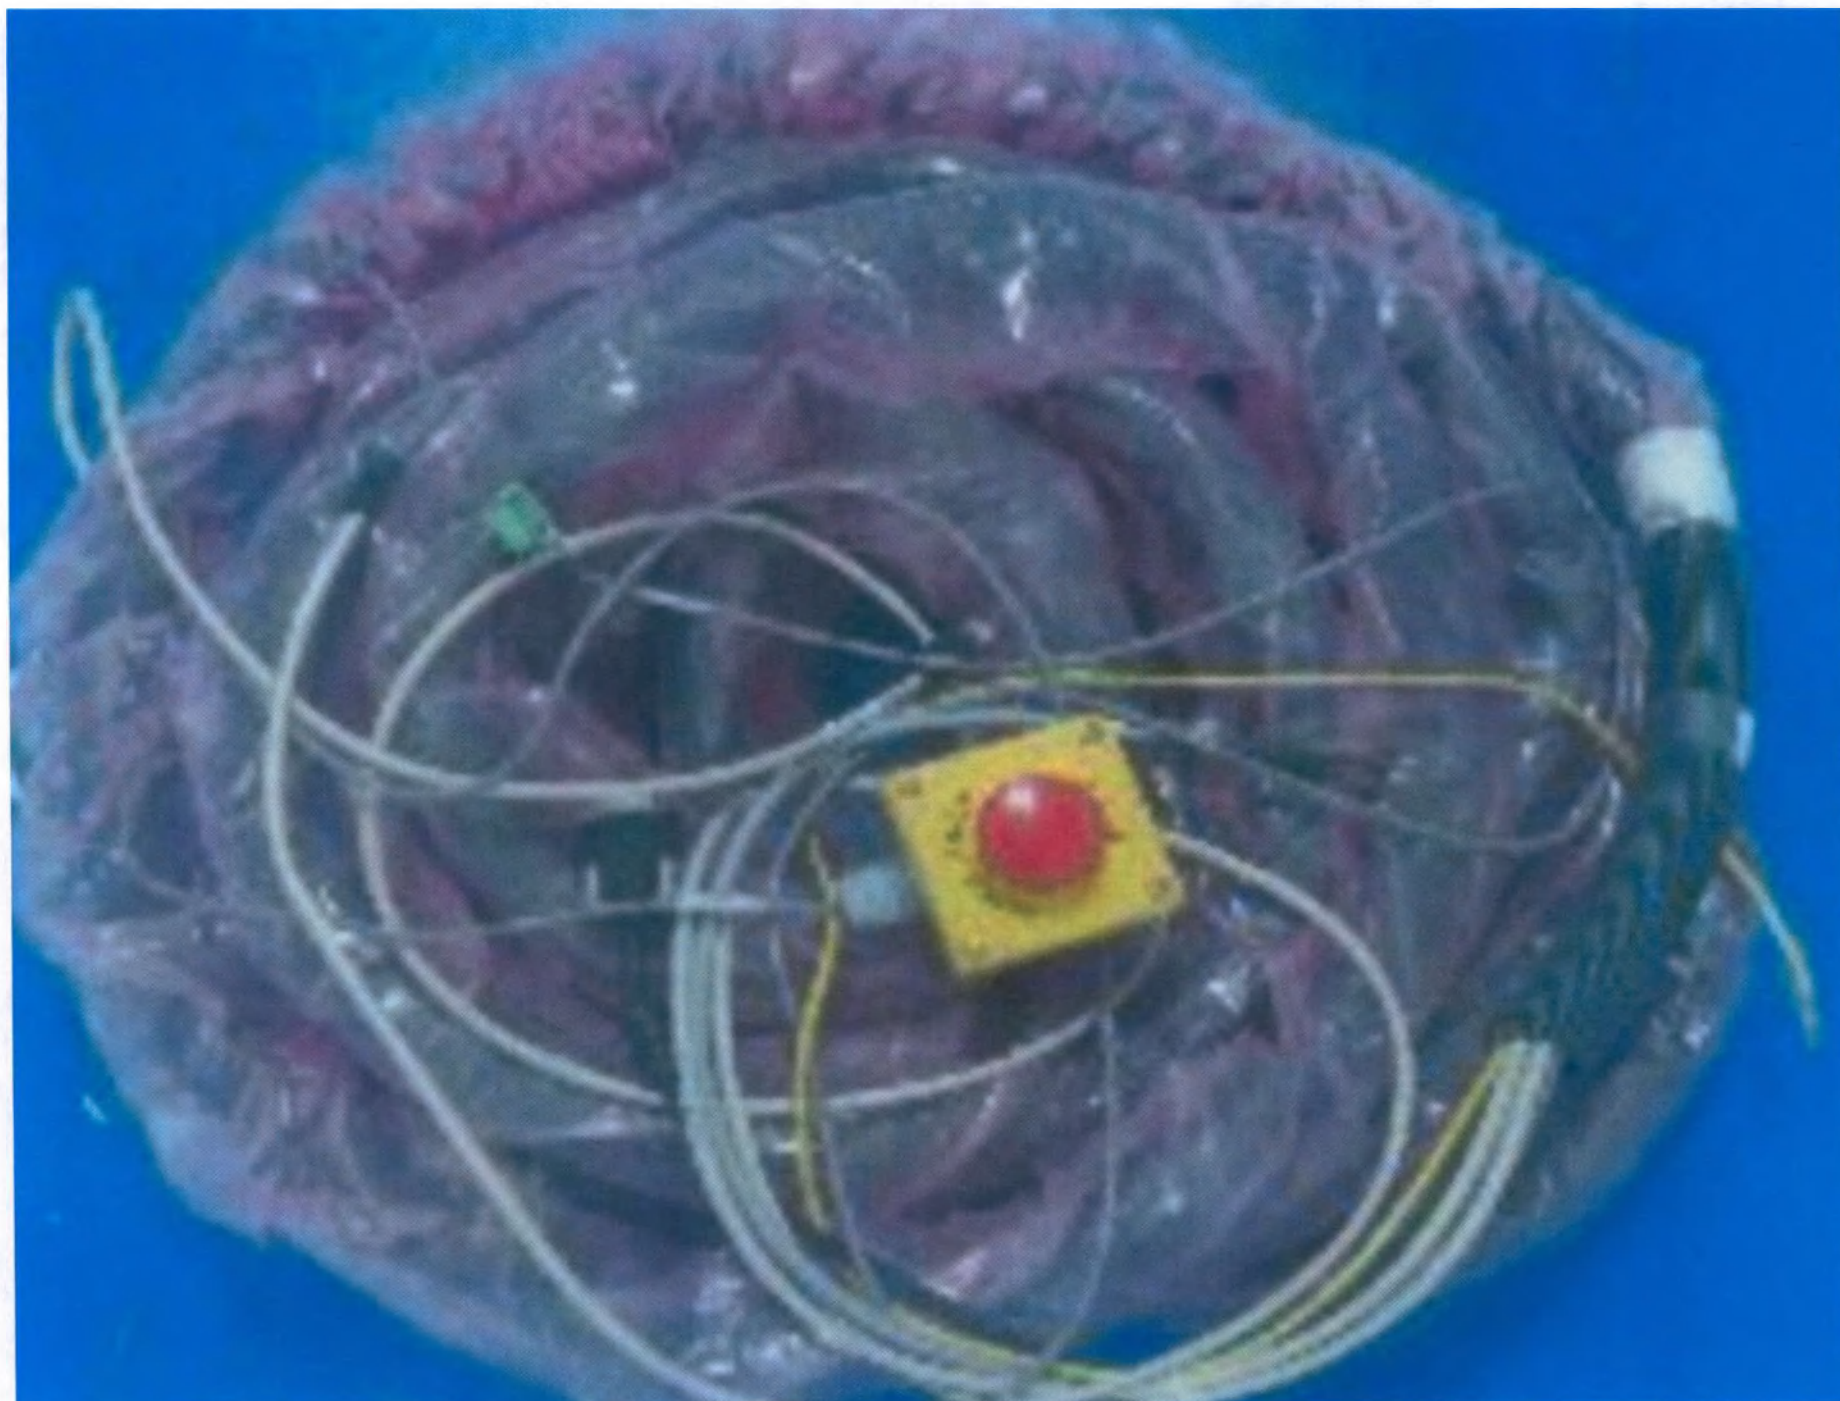







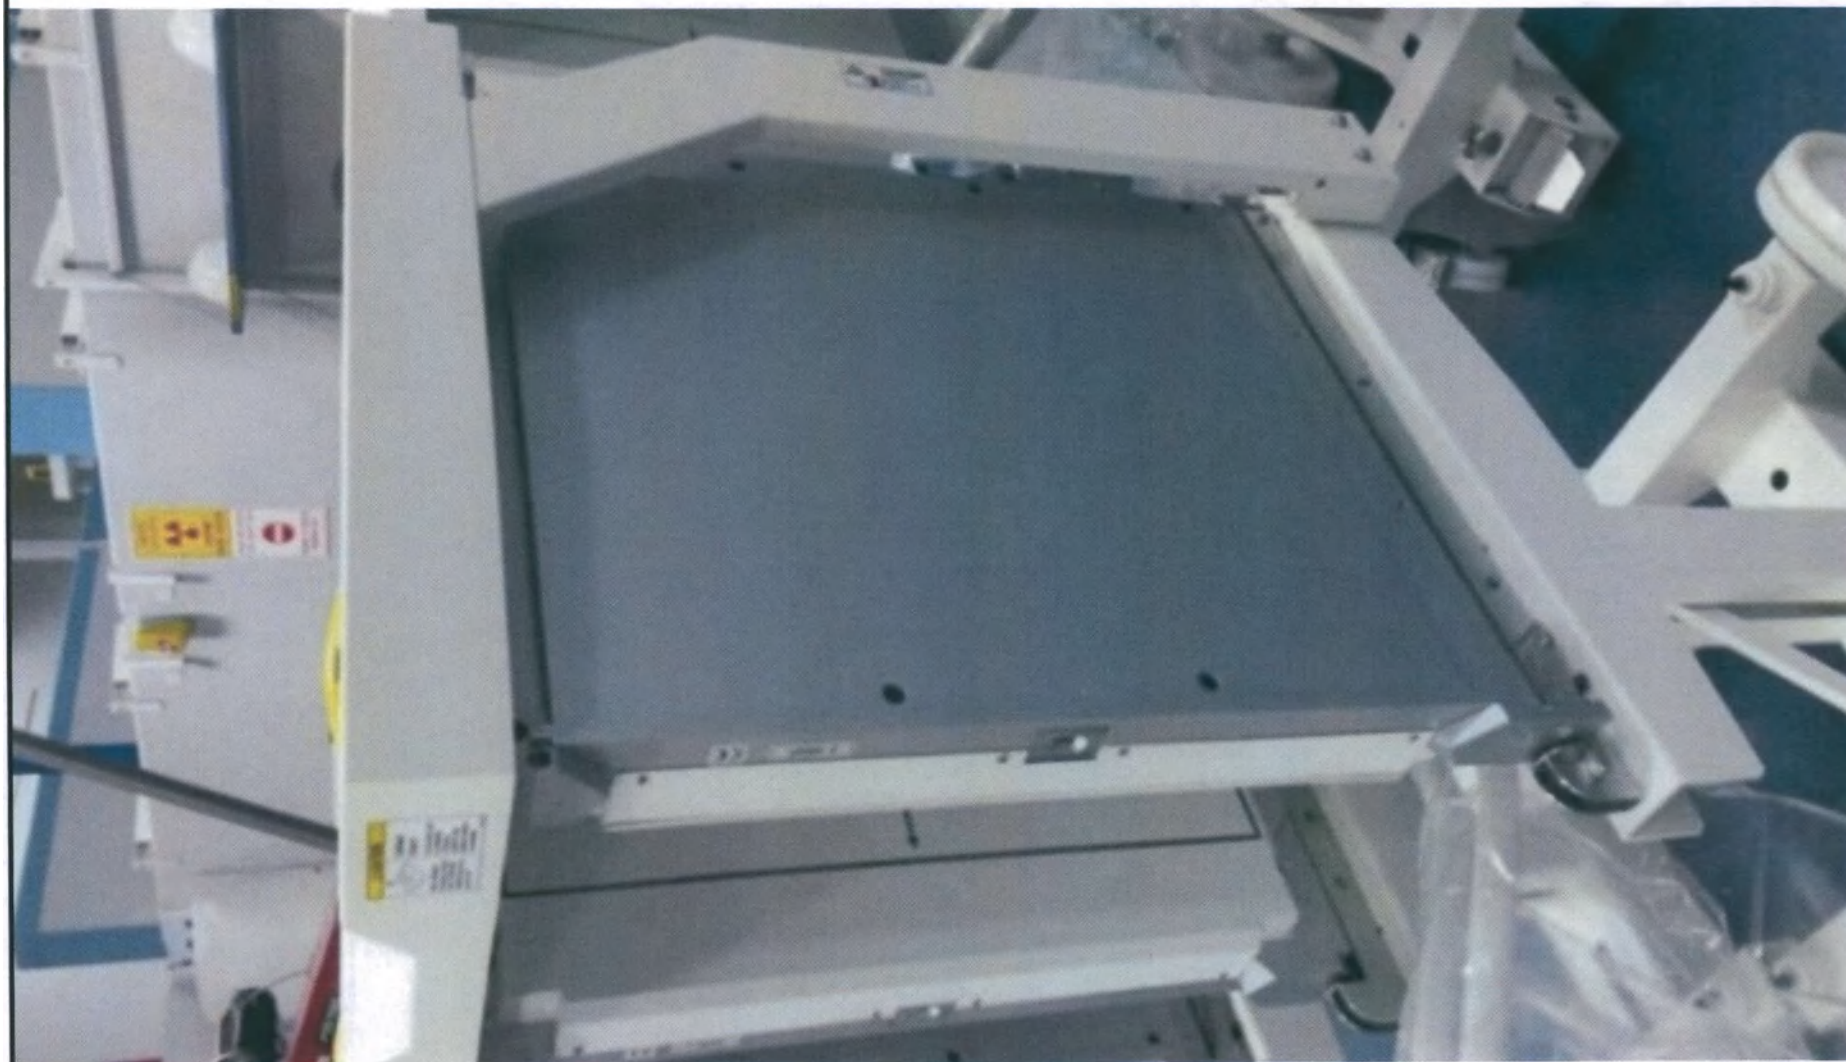







Низкоэнергетические коллиматоры высокого разрешения с высокой чувствительностью (LEHRS) (только для варианта исполнения NM 31 830)



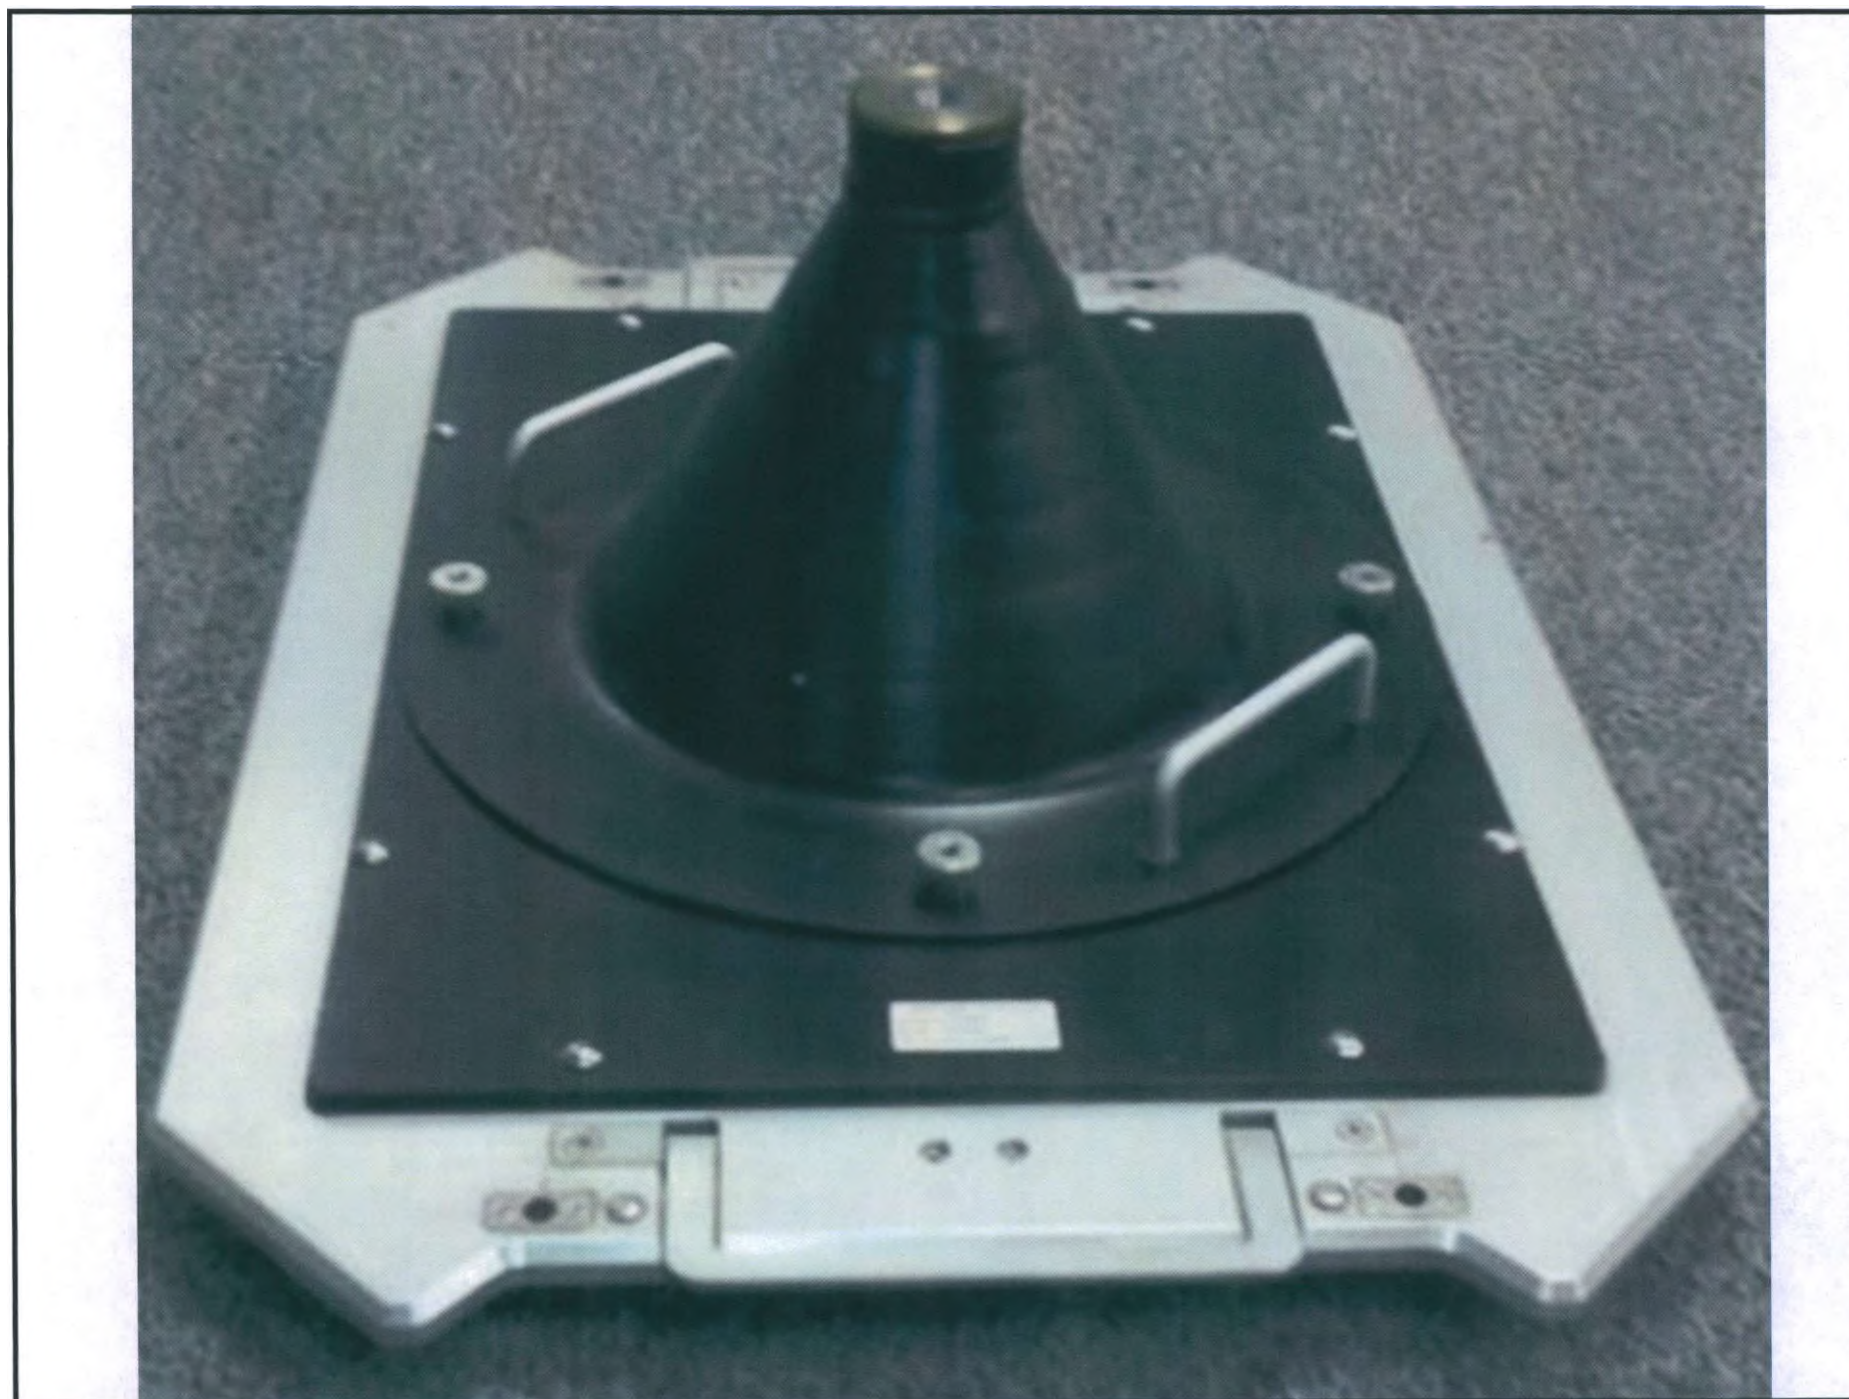

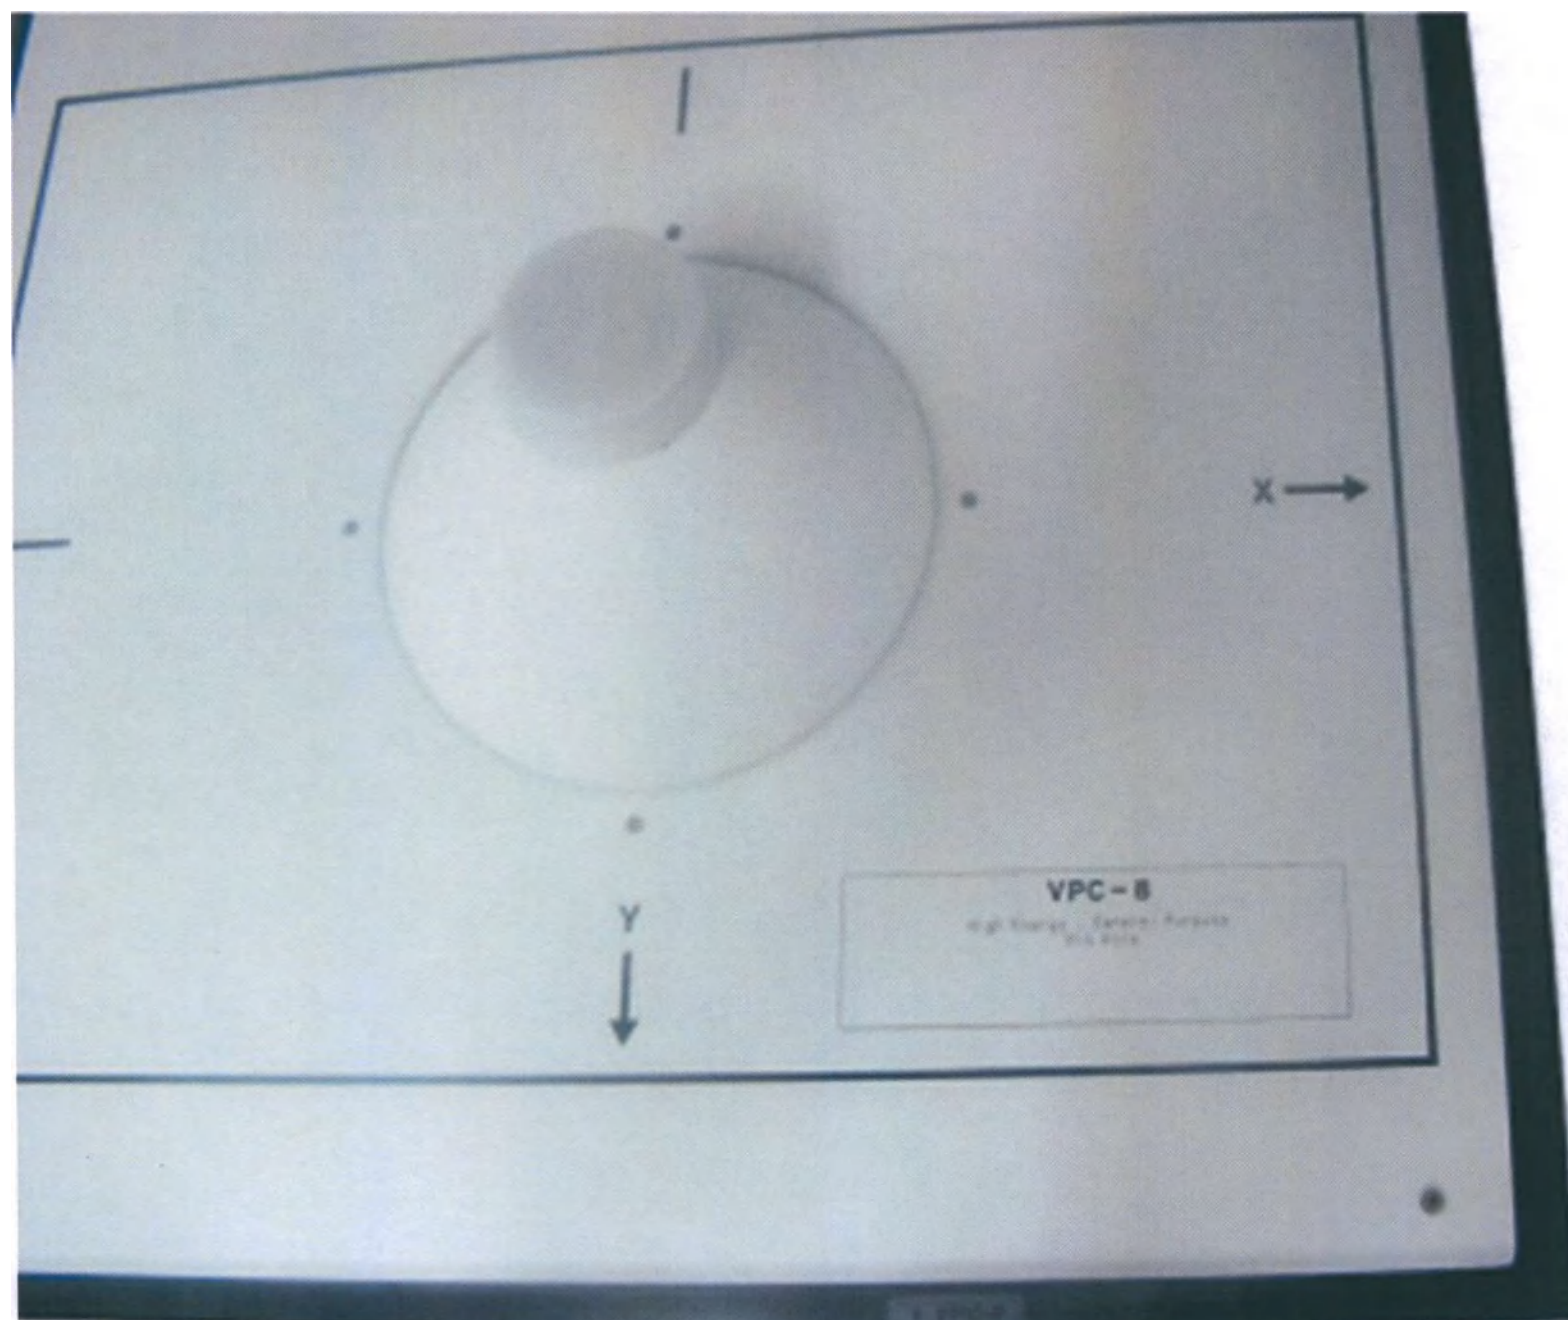




Внешние мониторы для синхронизации по ЭКГ 7600, производства Ivy Biomedical Systems, Inc., США (для вариантов исполнения **Discovery NM 630** и **NM 830**)




Внешние мониторы для синхронизации по ЭКГ 7600, производства Ivy Biomedical Systems, Inc., США (для вариантов исполнения **Discovery NM 630** и **NM 830**)



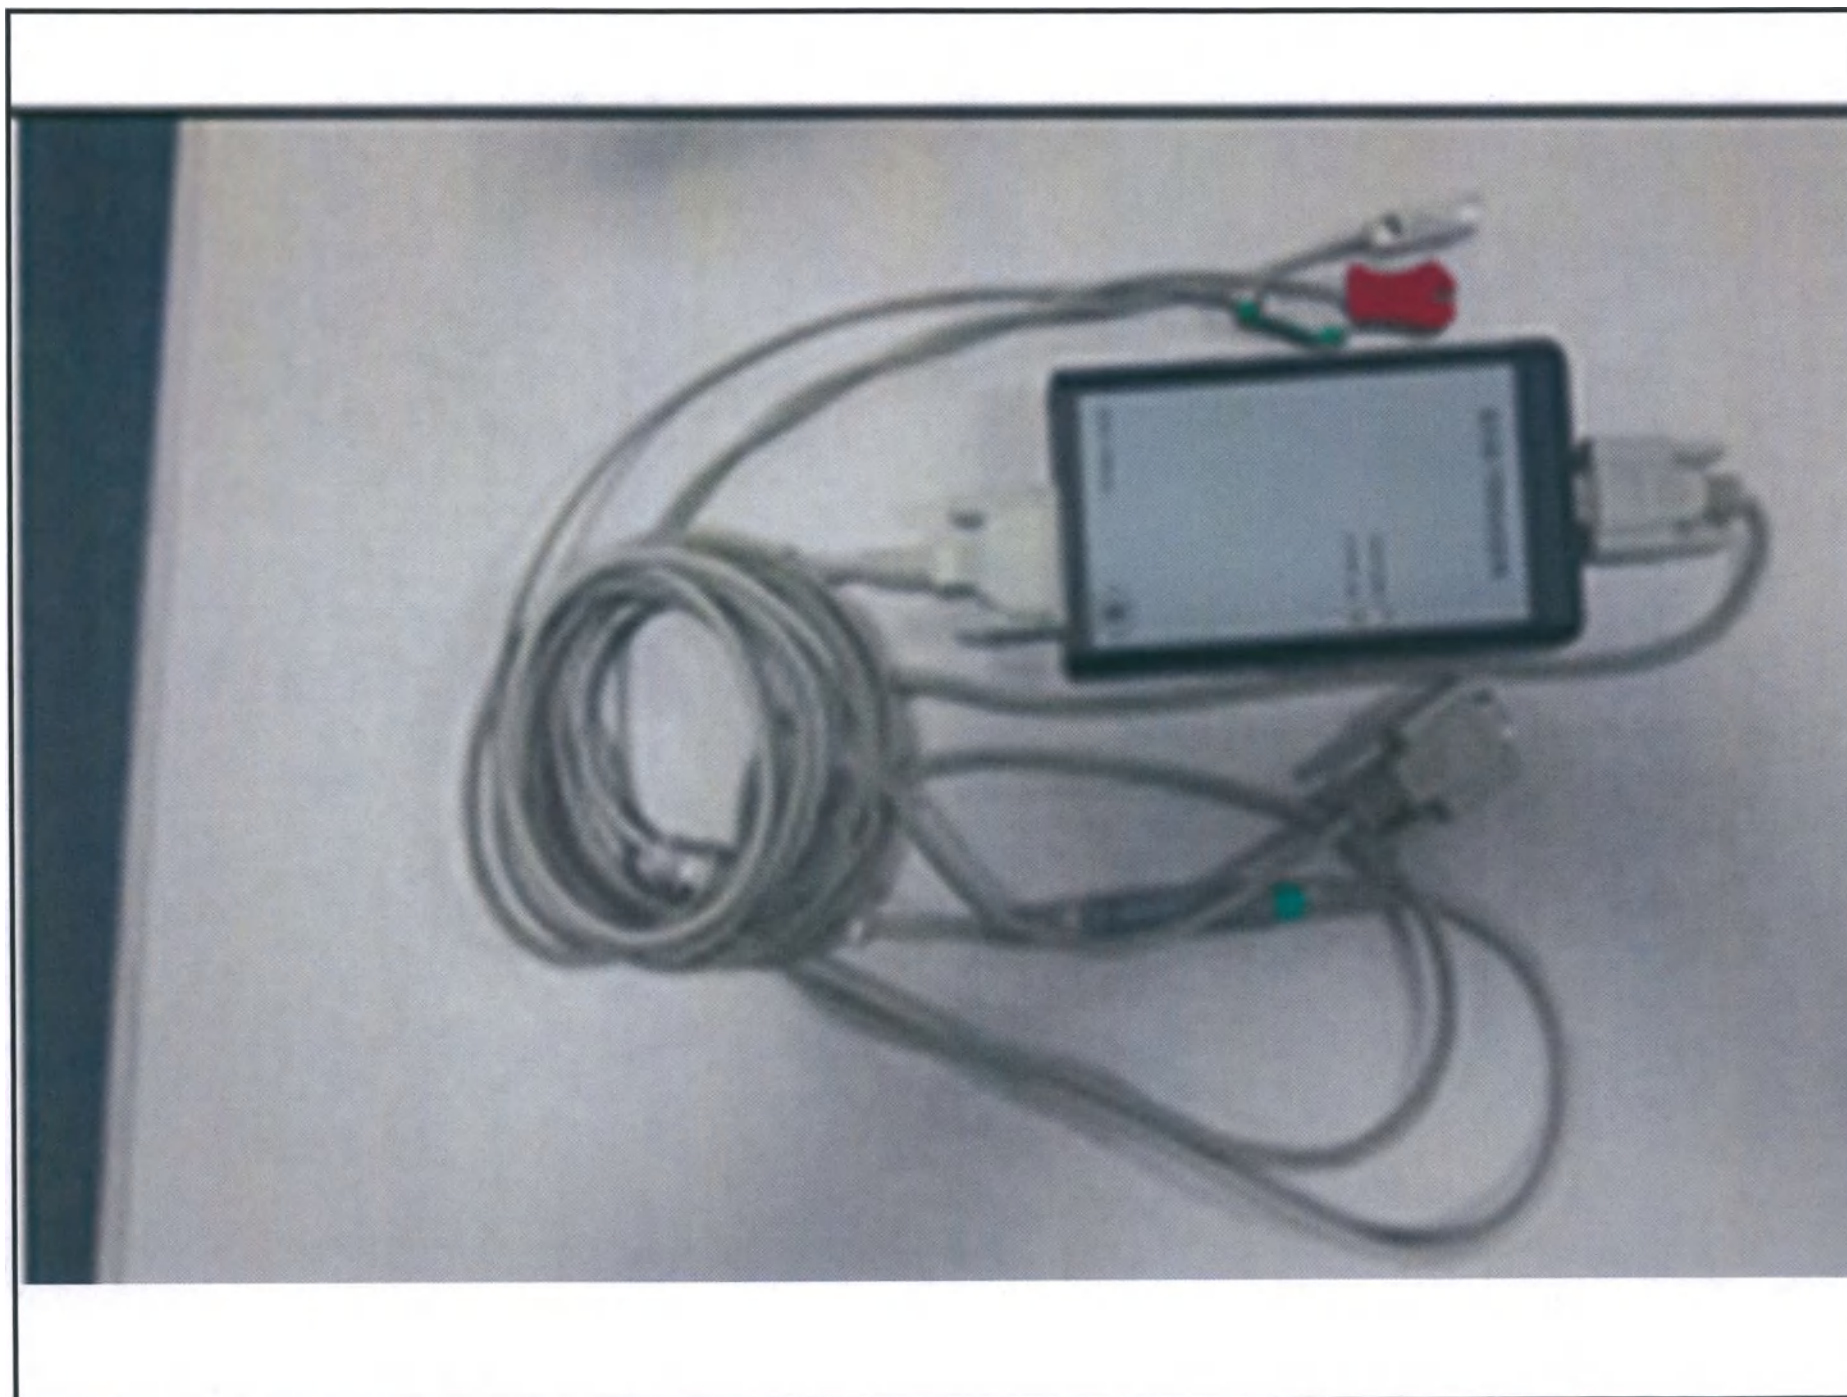





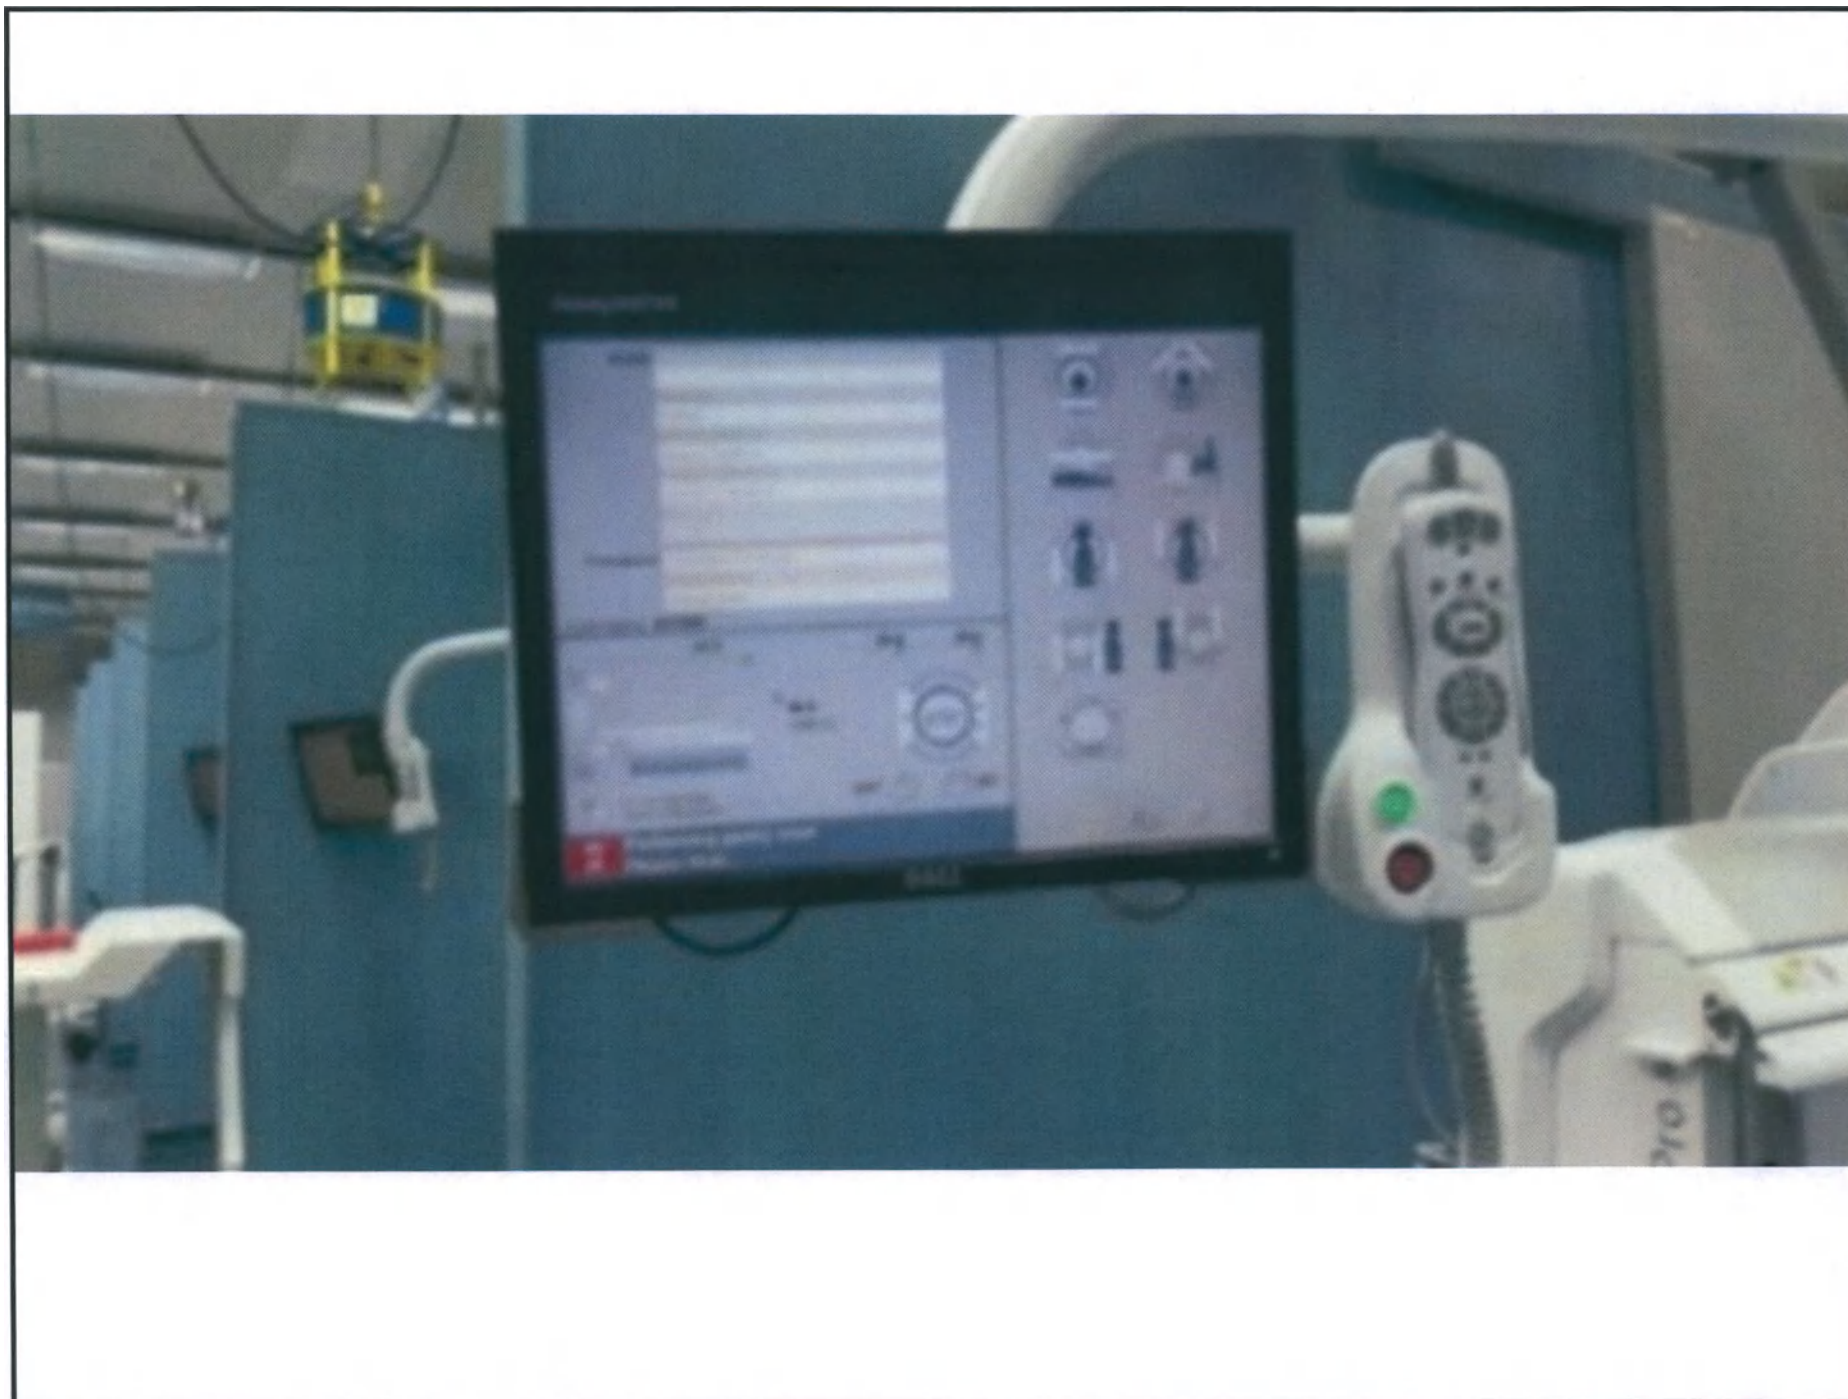






II. Принадлежности:

43

Столы оператора. (для вариантов исполнения **Discovery NM 630** и **NM 830**)



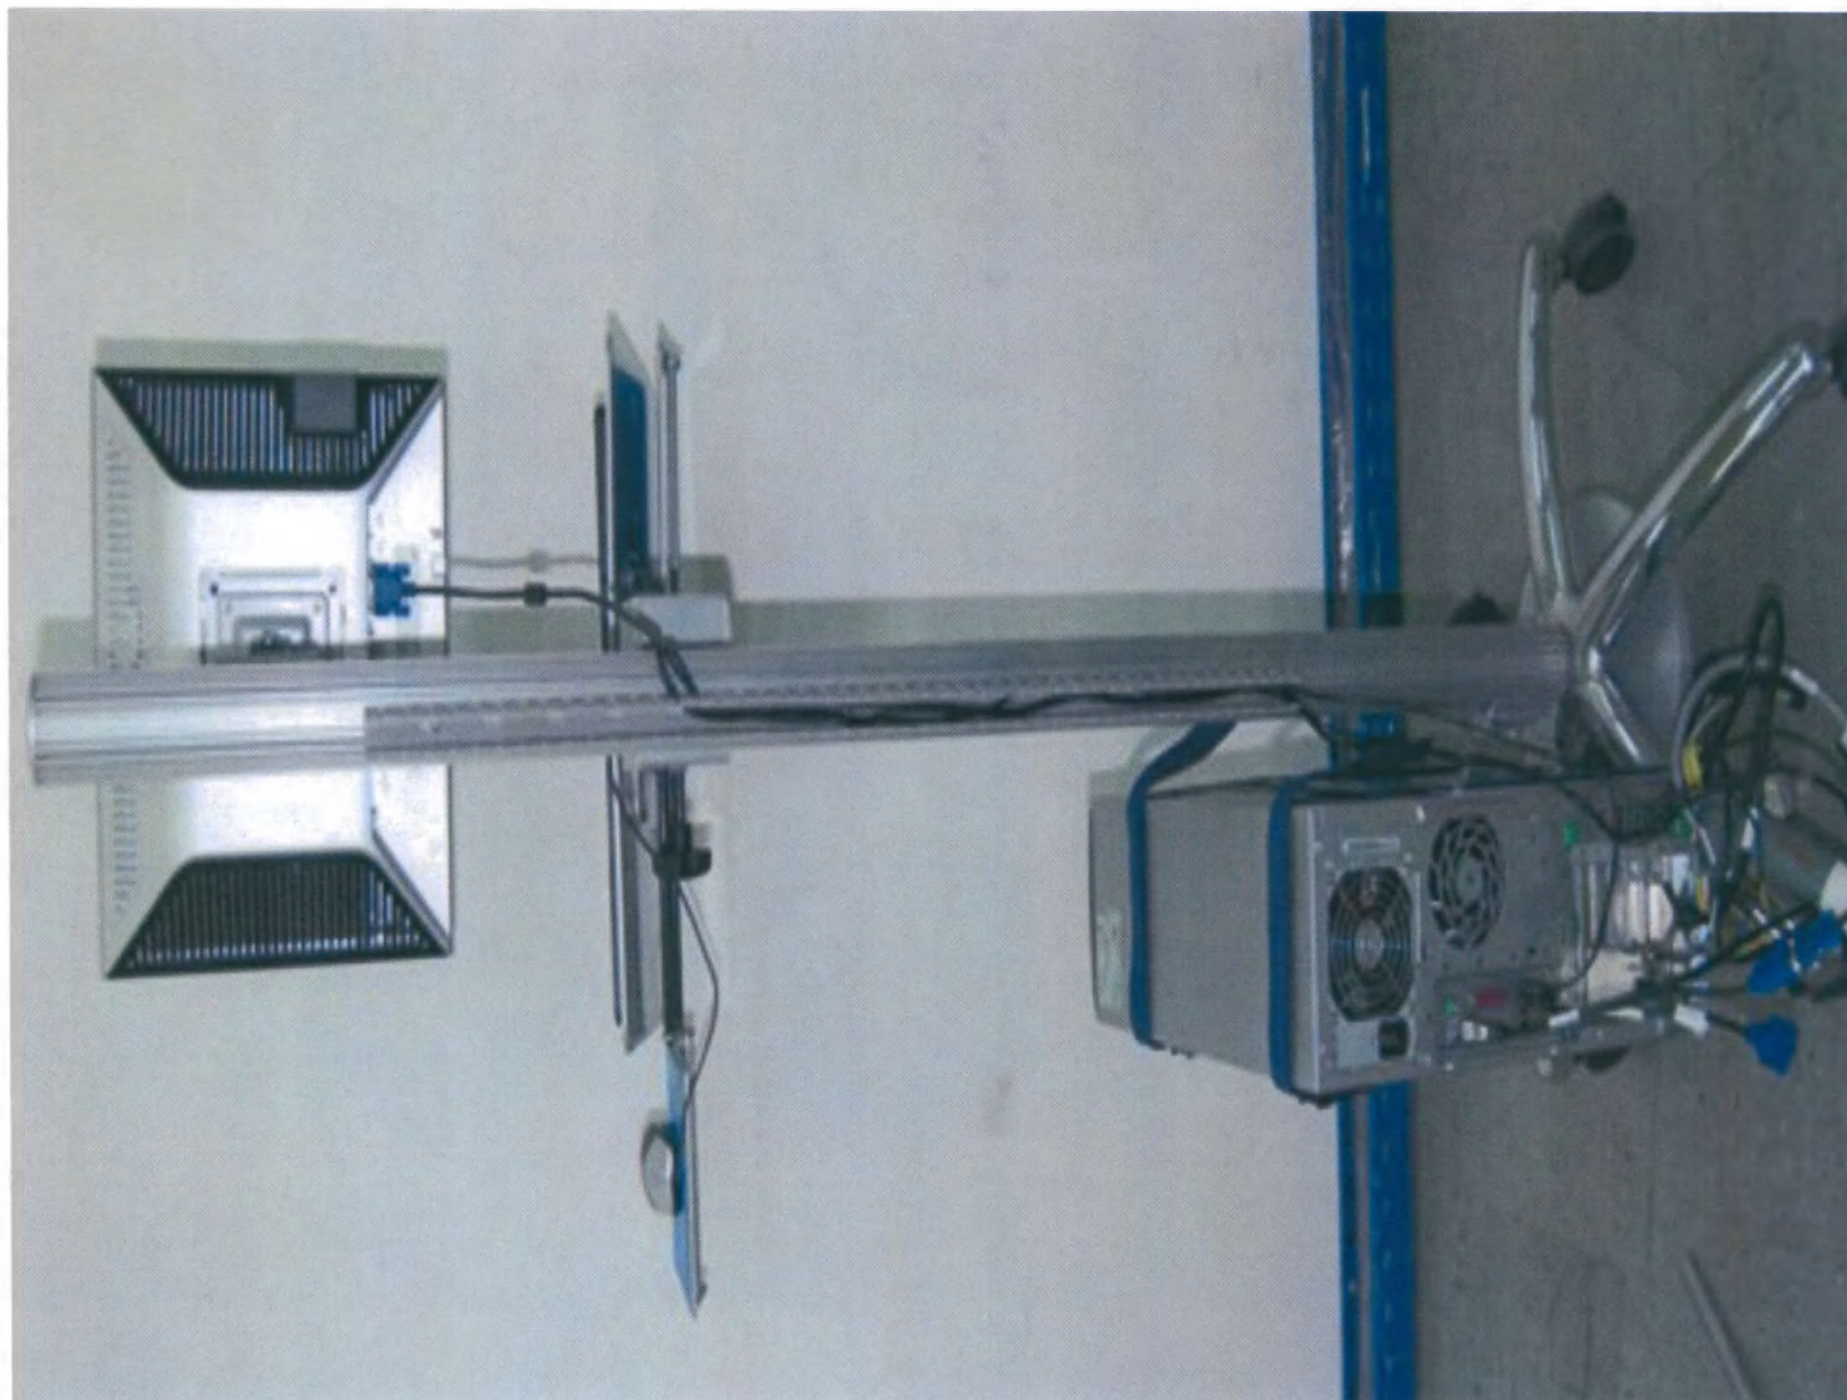












Держатели источника для КК ЯМ-исследования (или держатели источника для КК COR), используемые для проверки центра вращения 50 при SPECT. (для вариантов исполнения **Discovery NM 630** и **NM 830**)








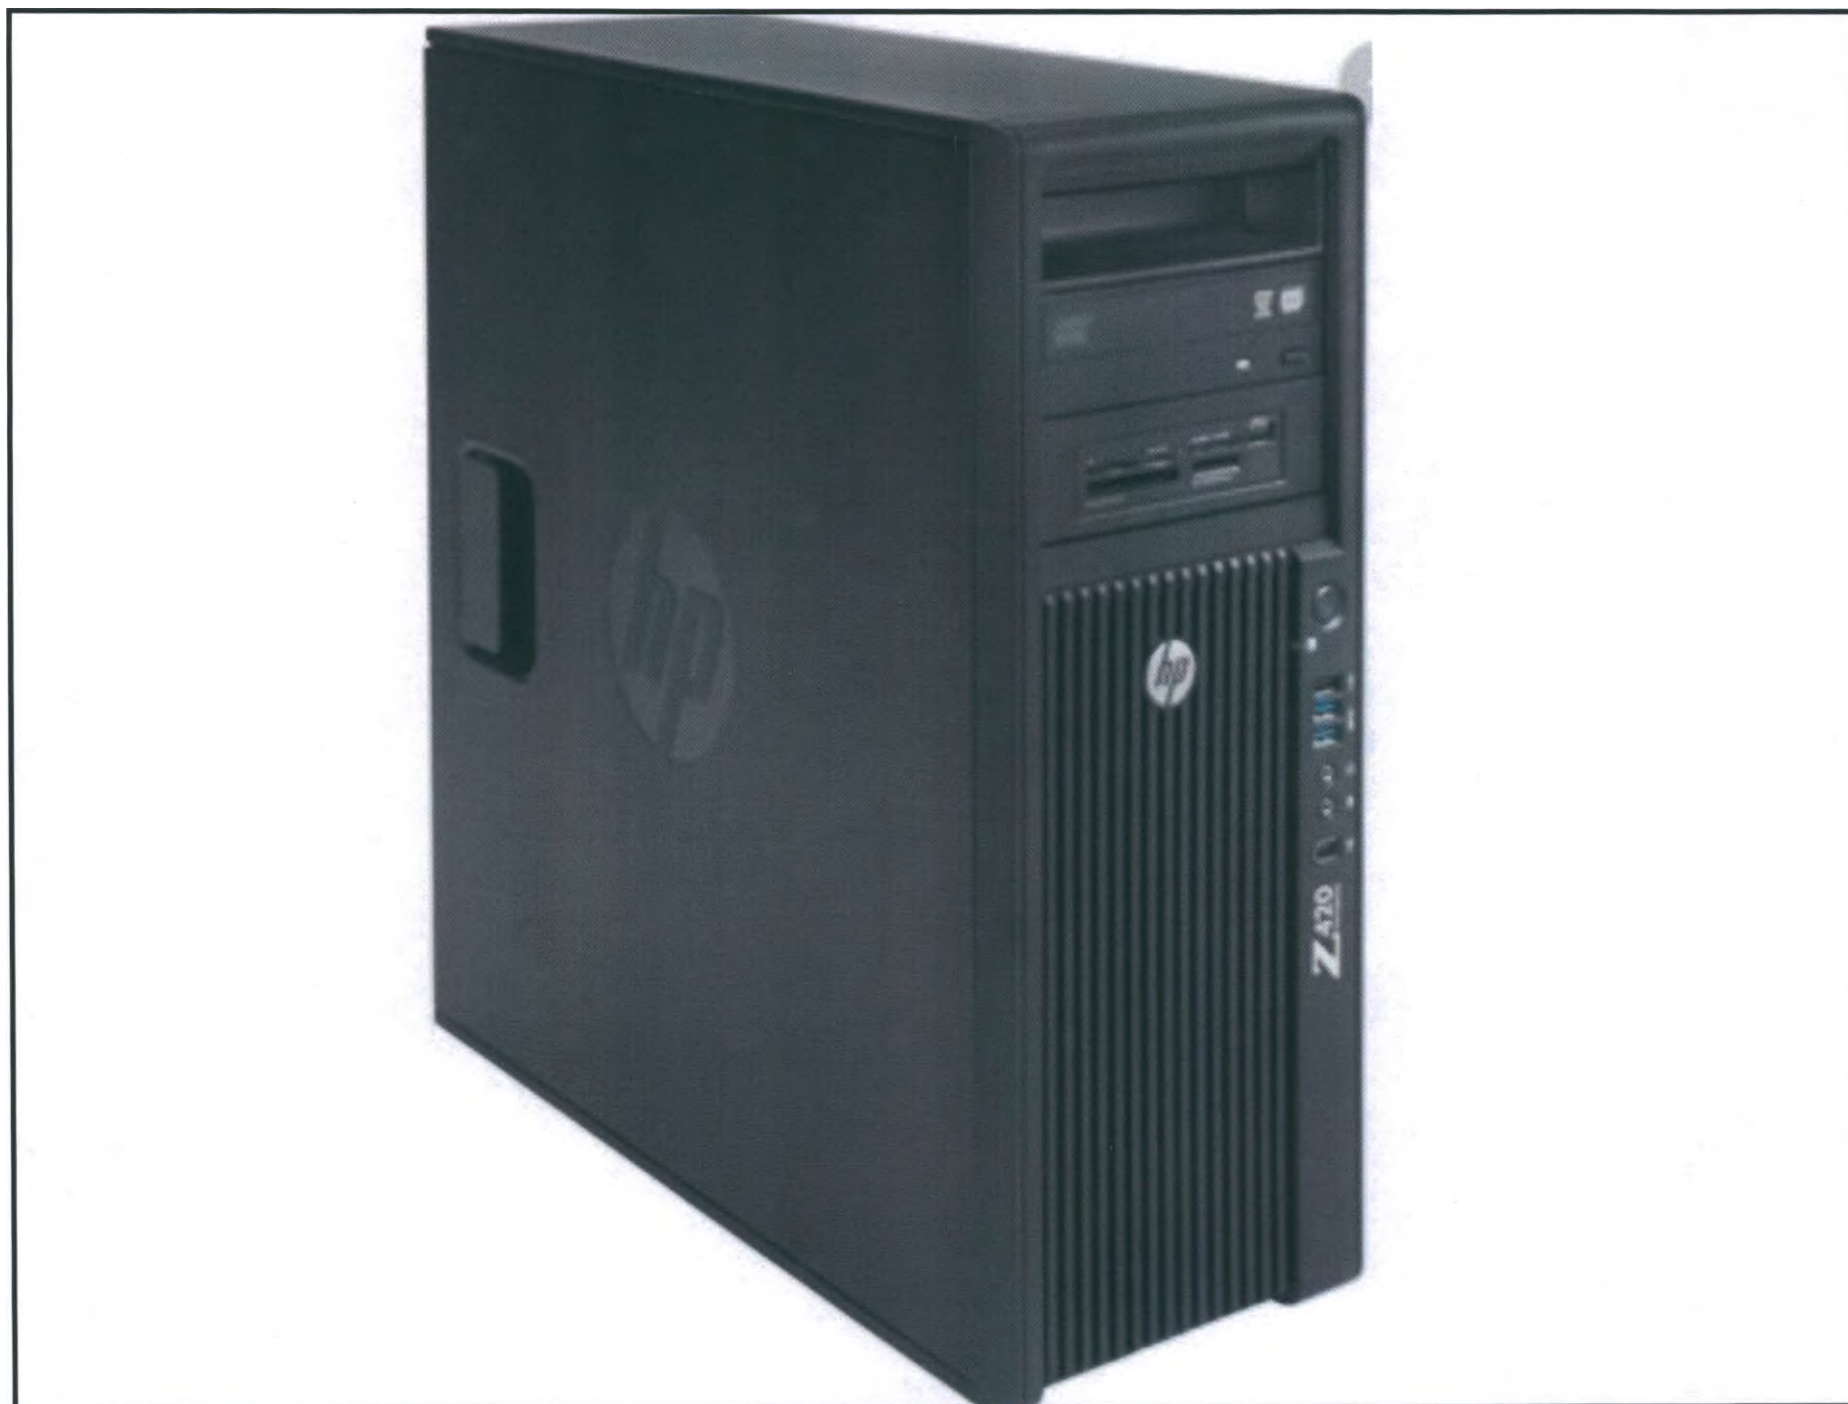









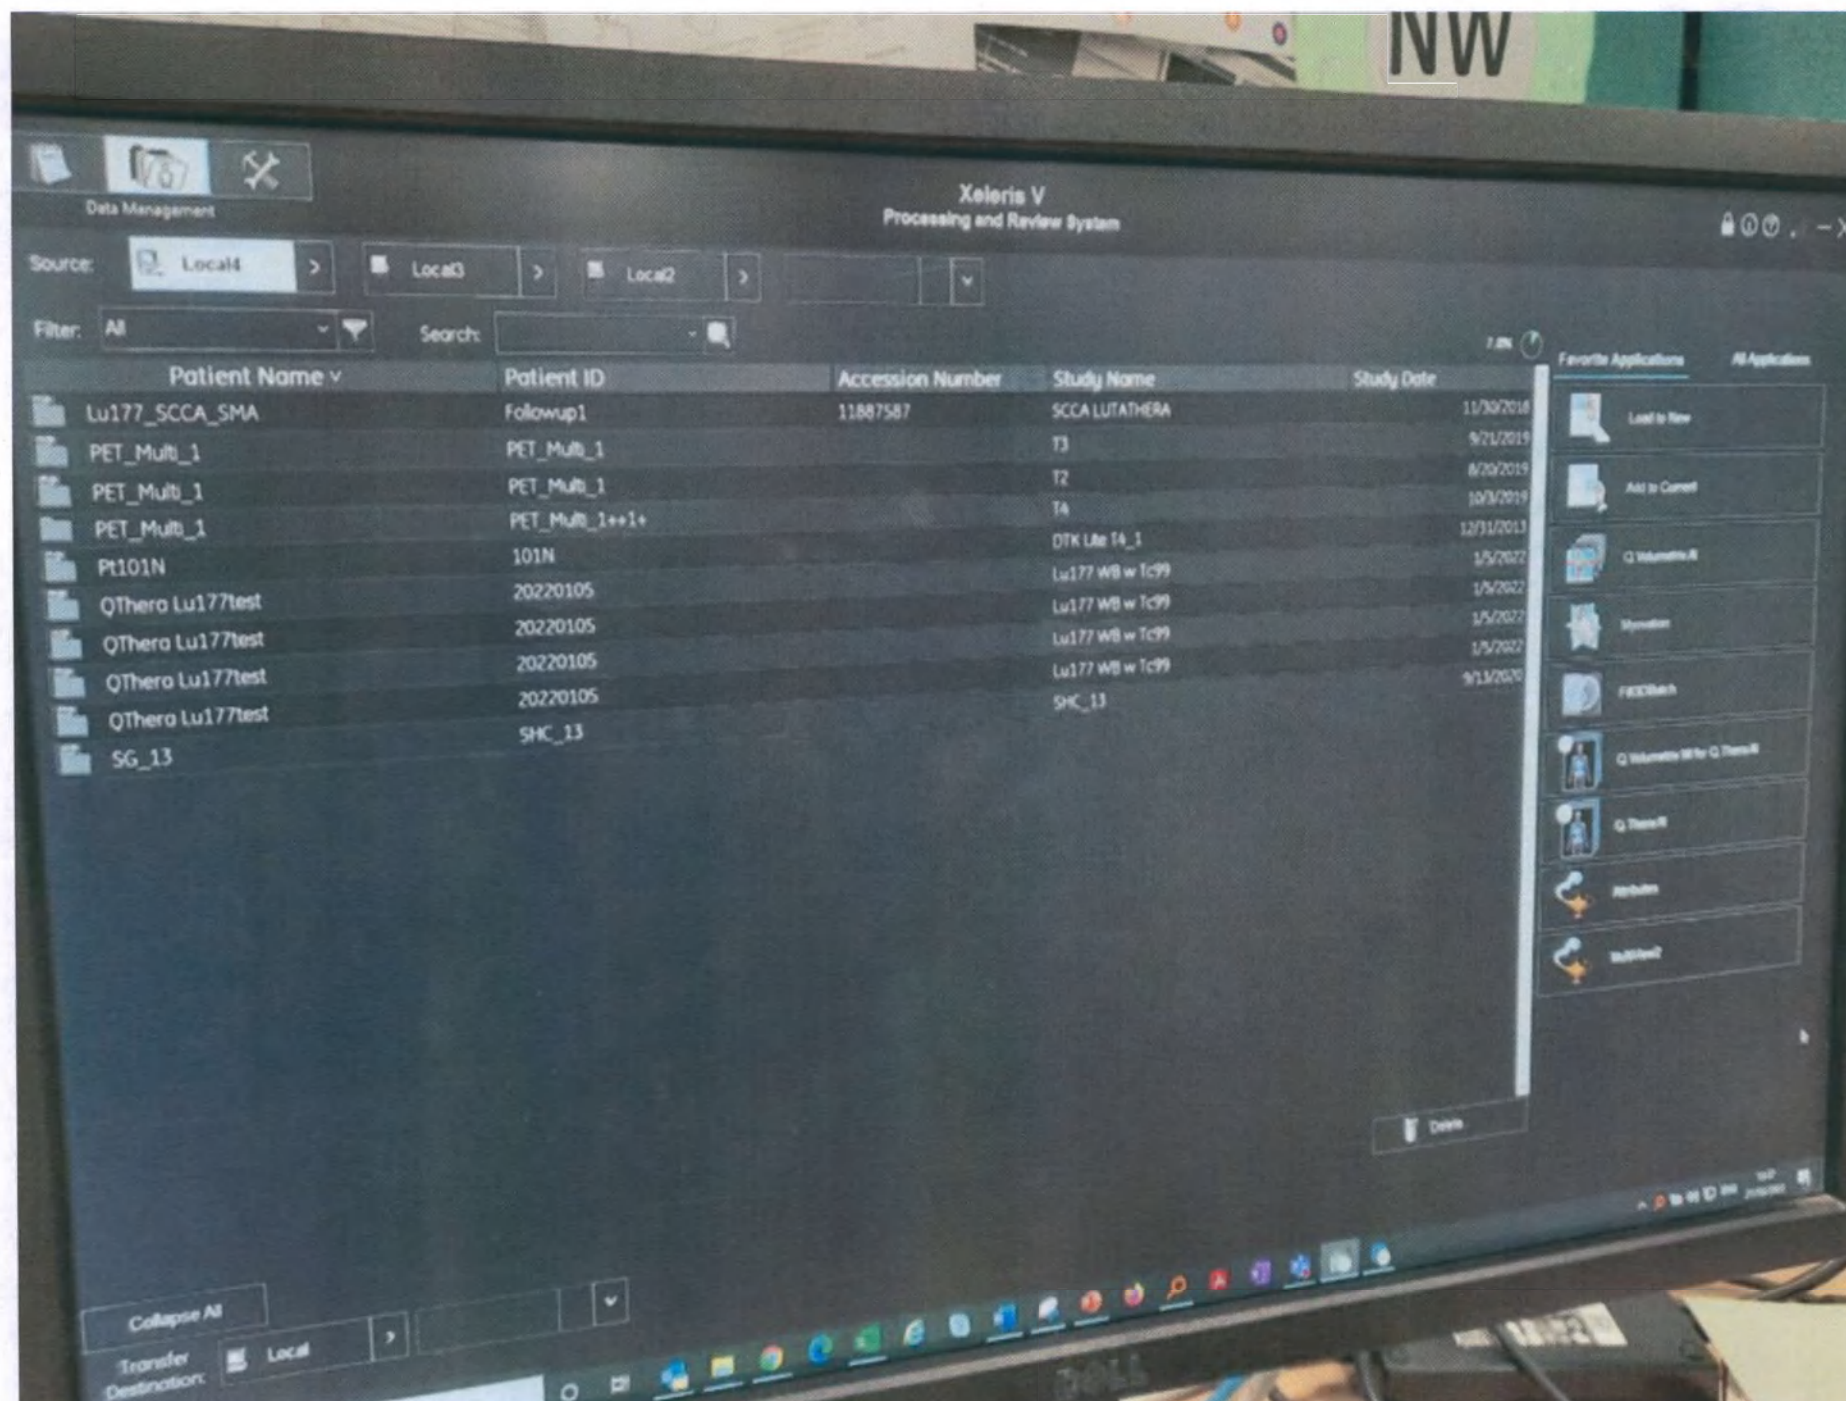




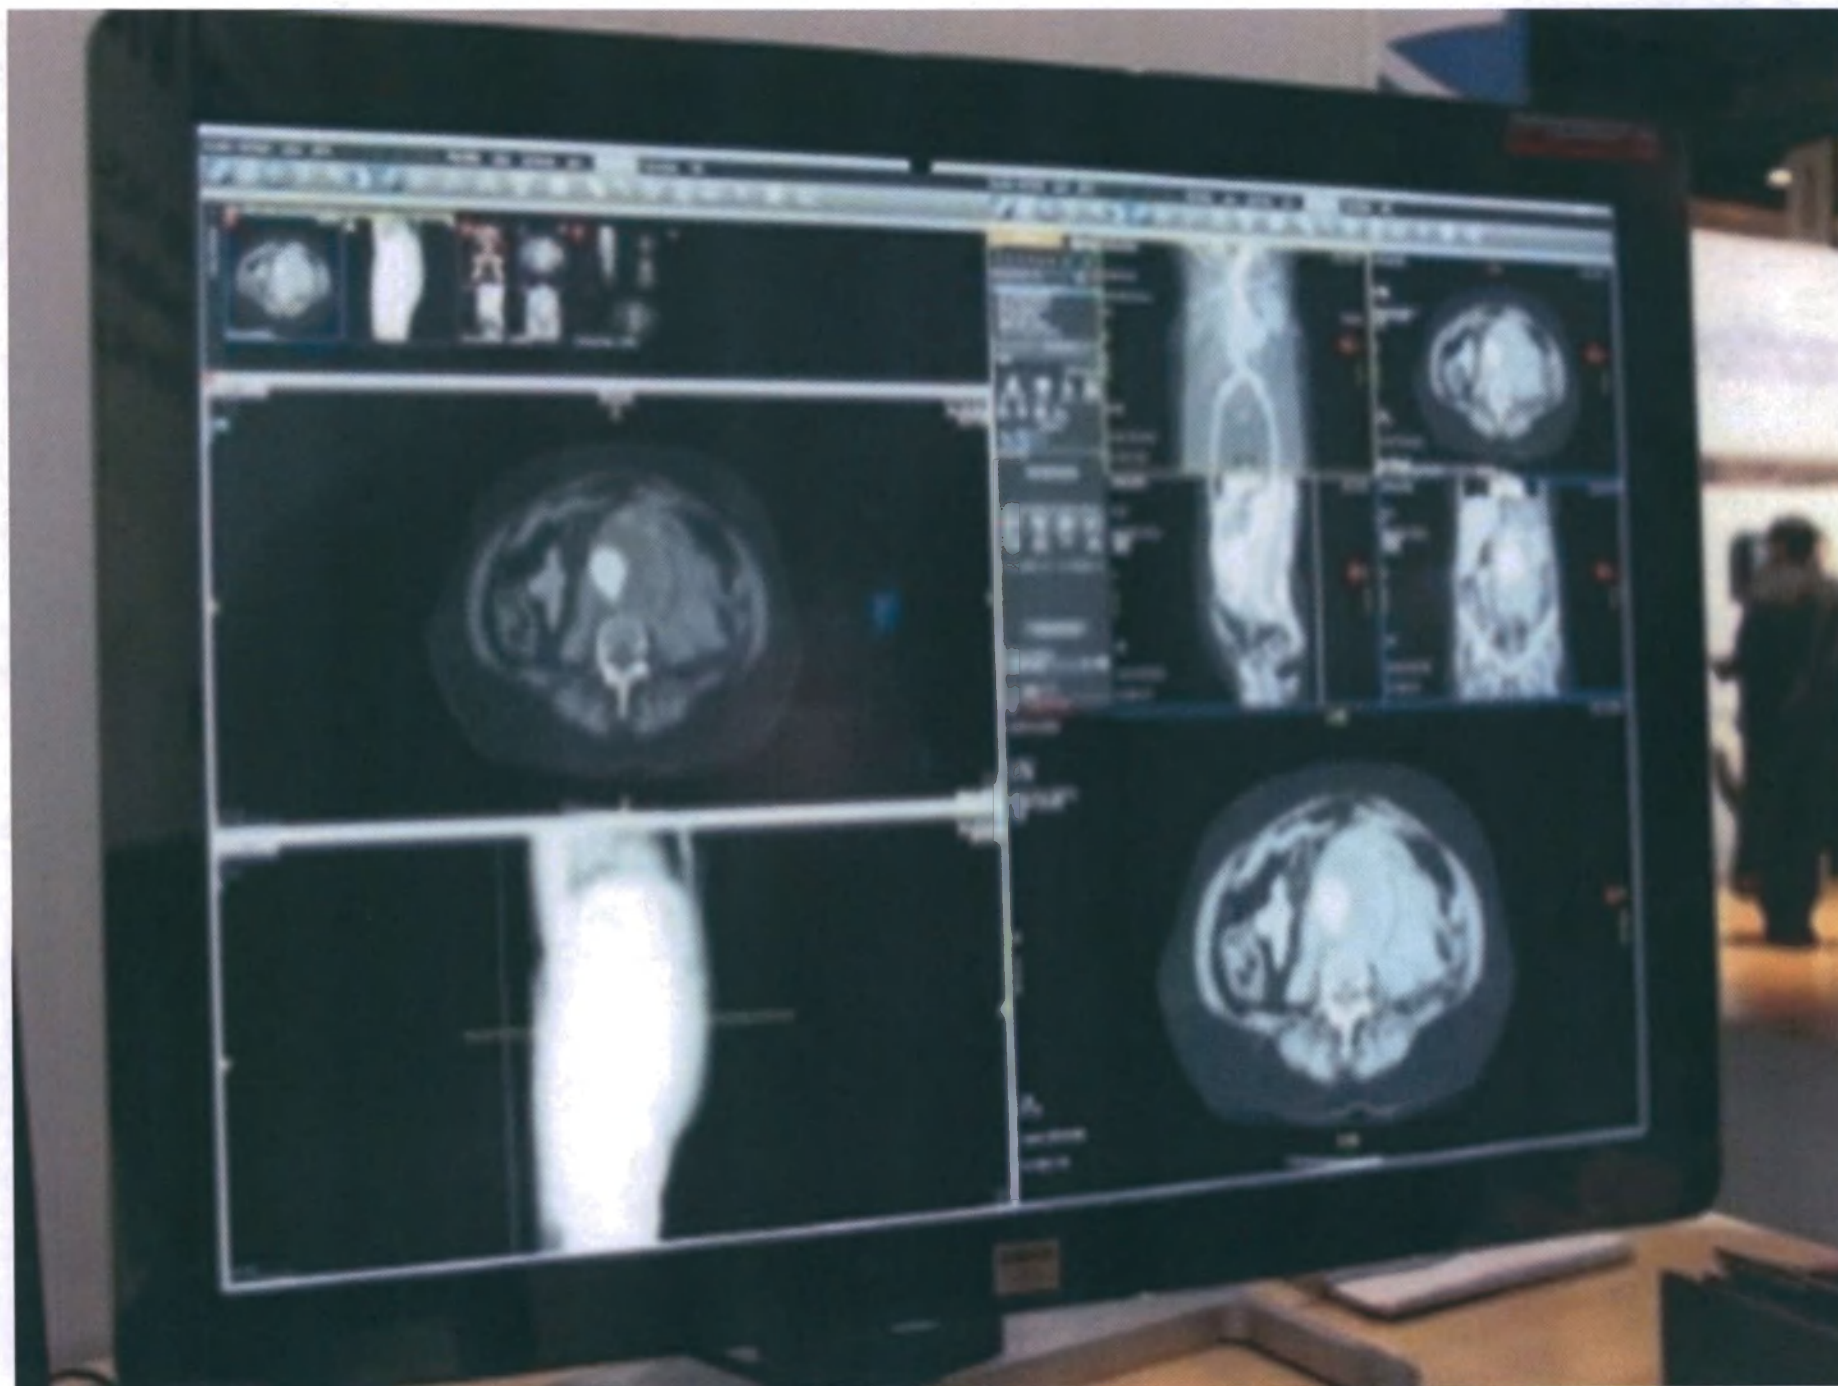

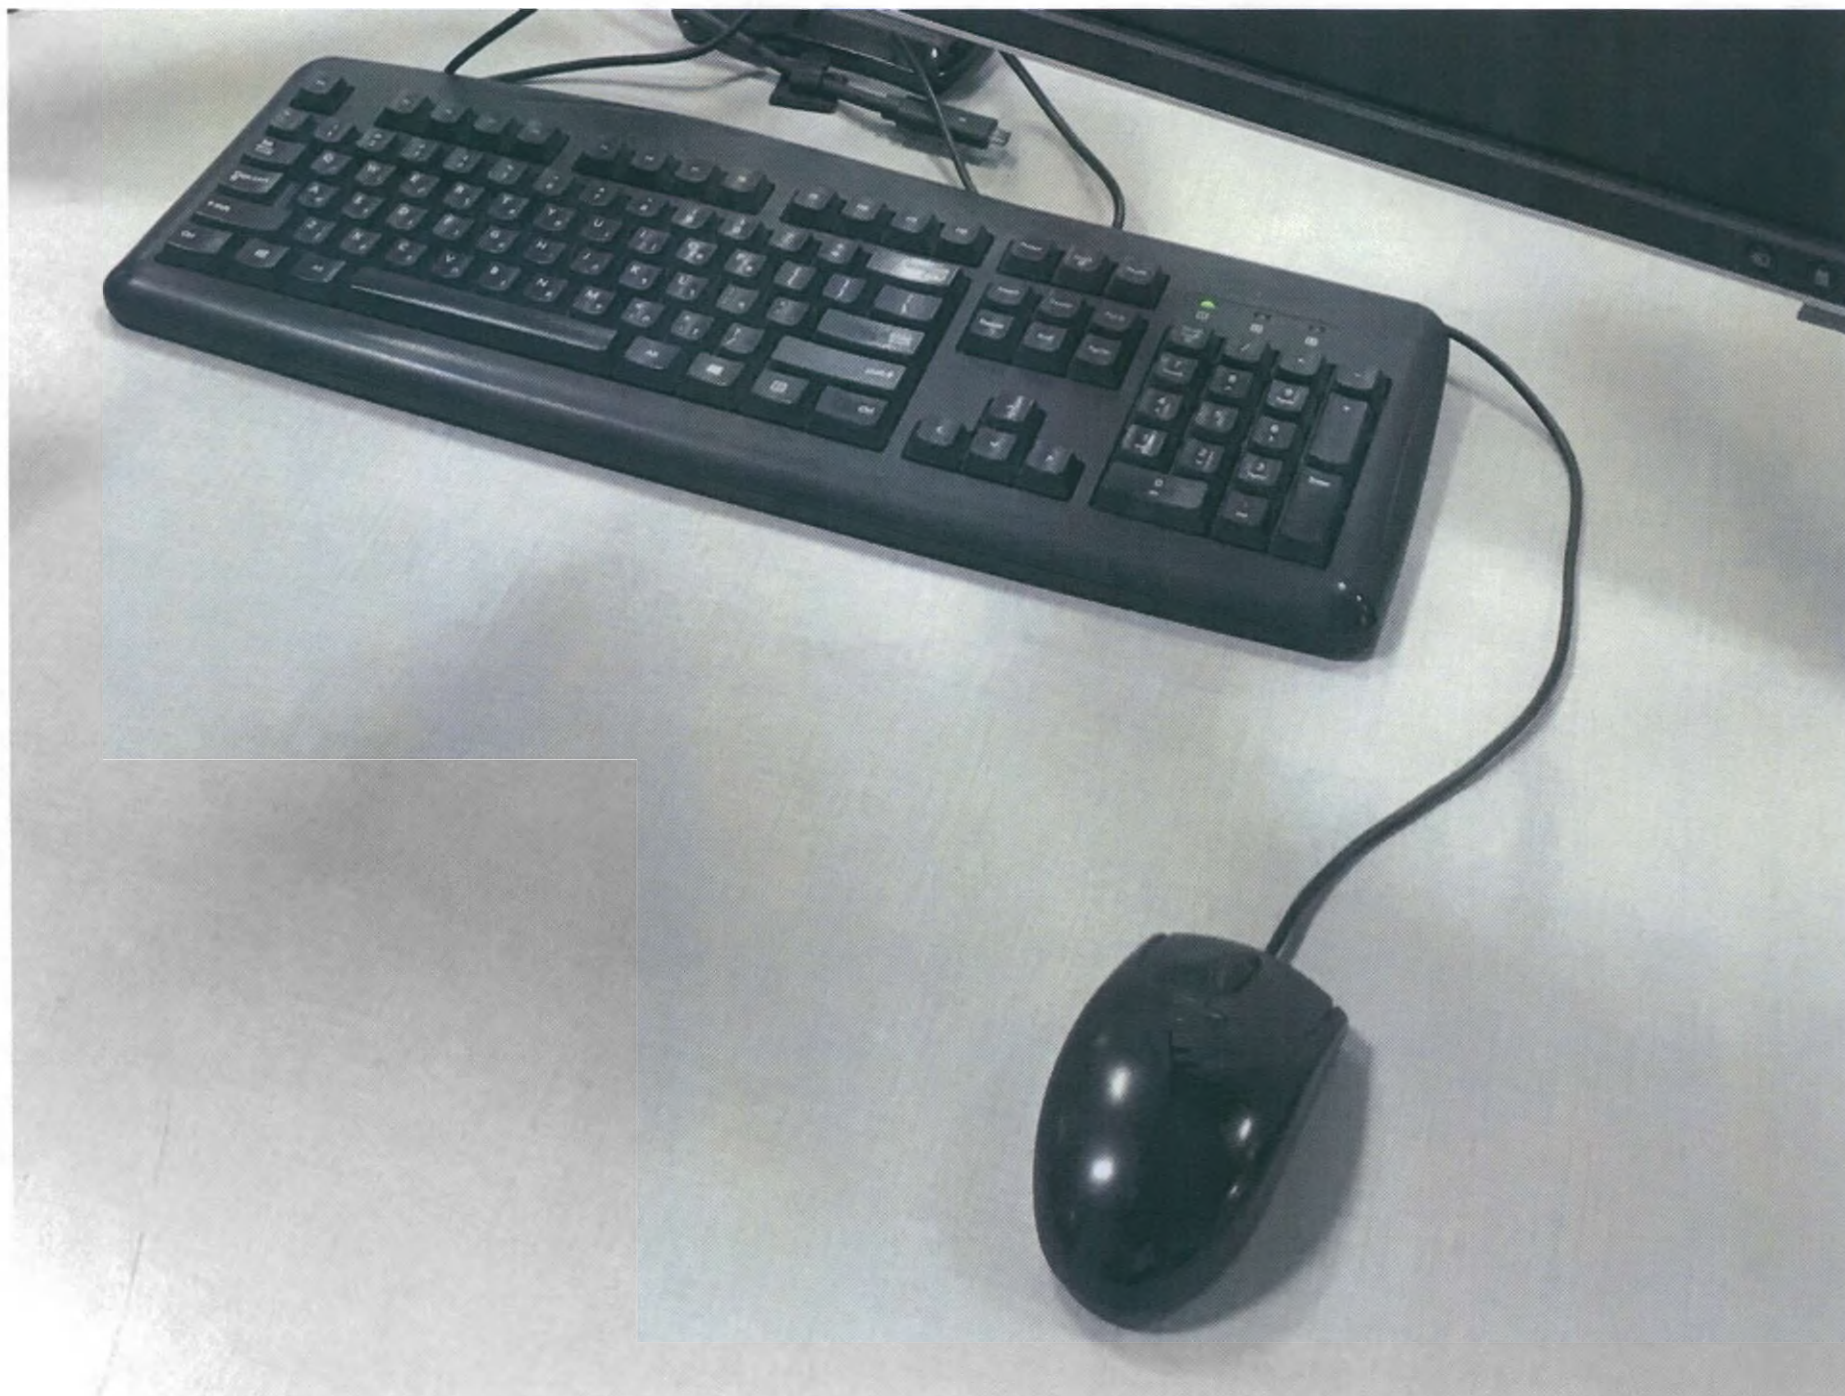




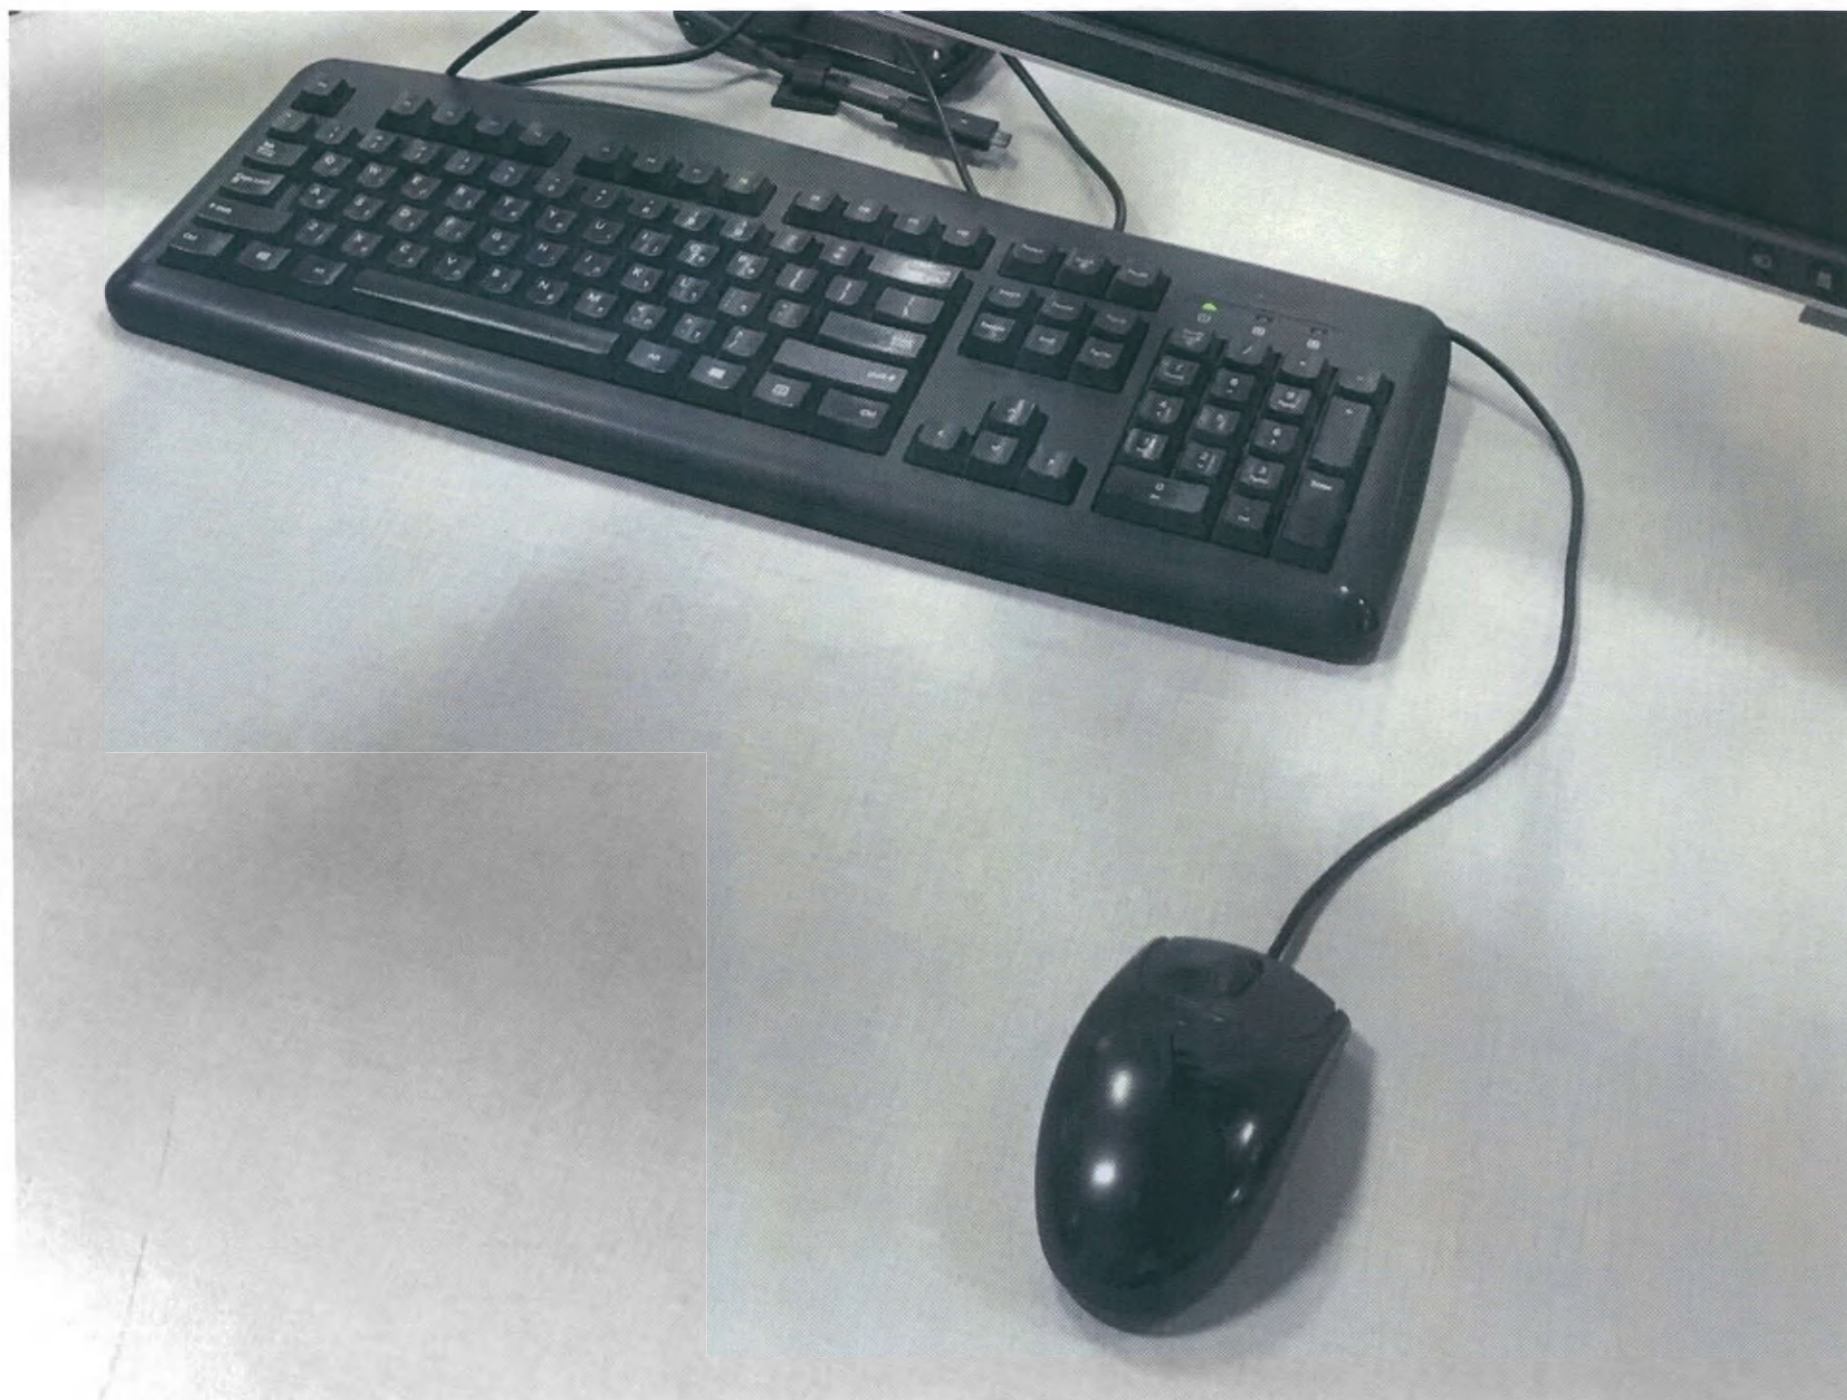










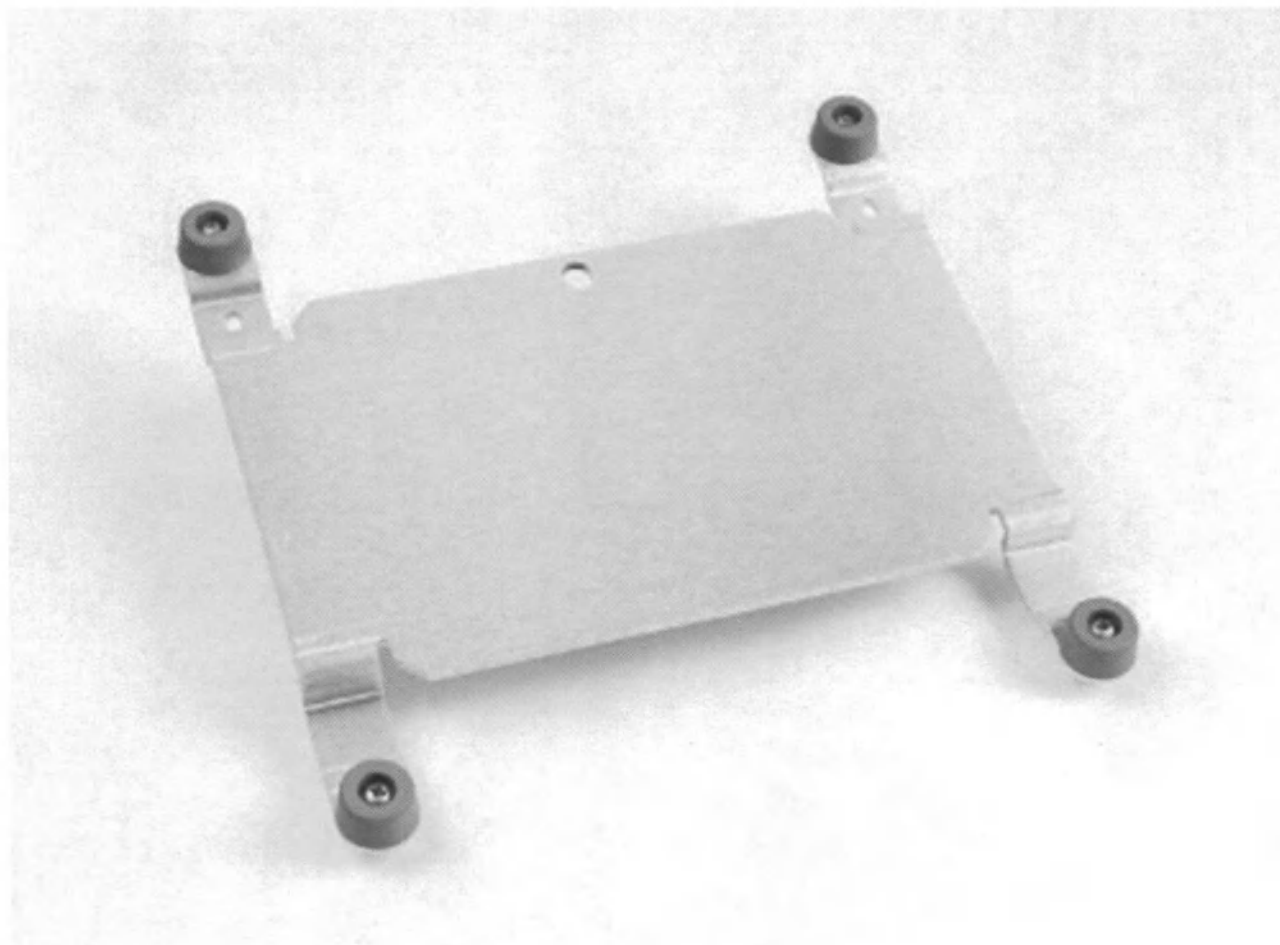

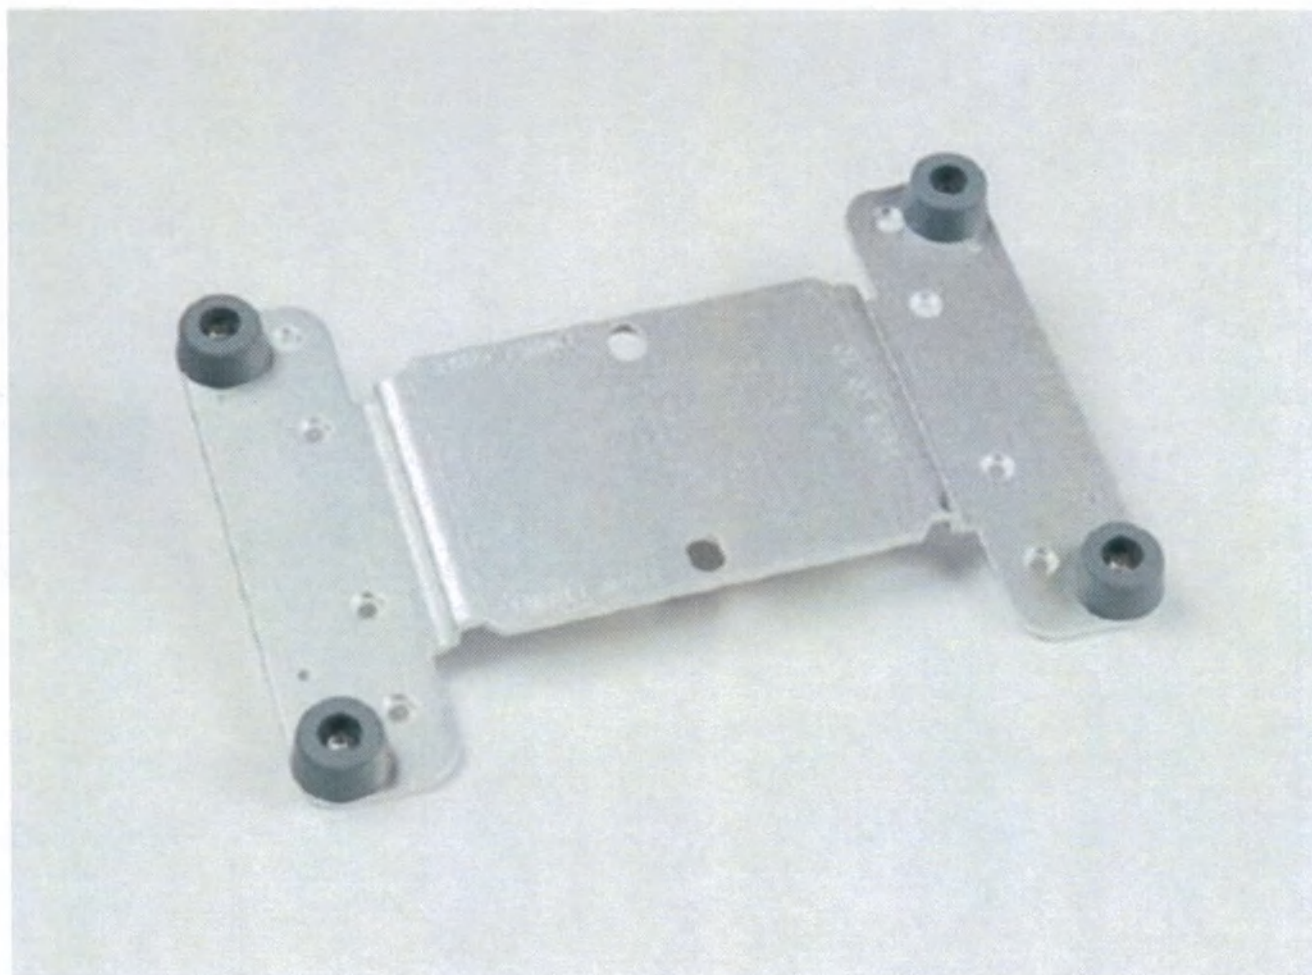

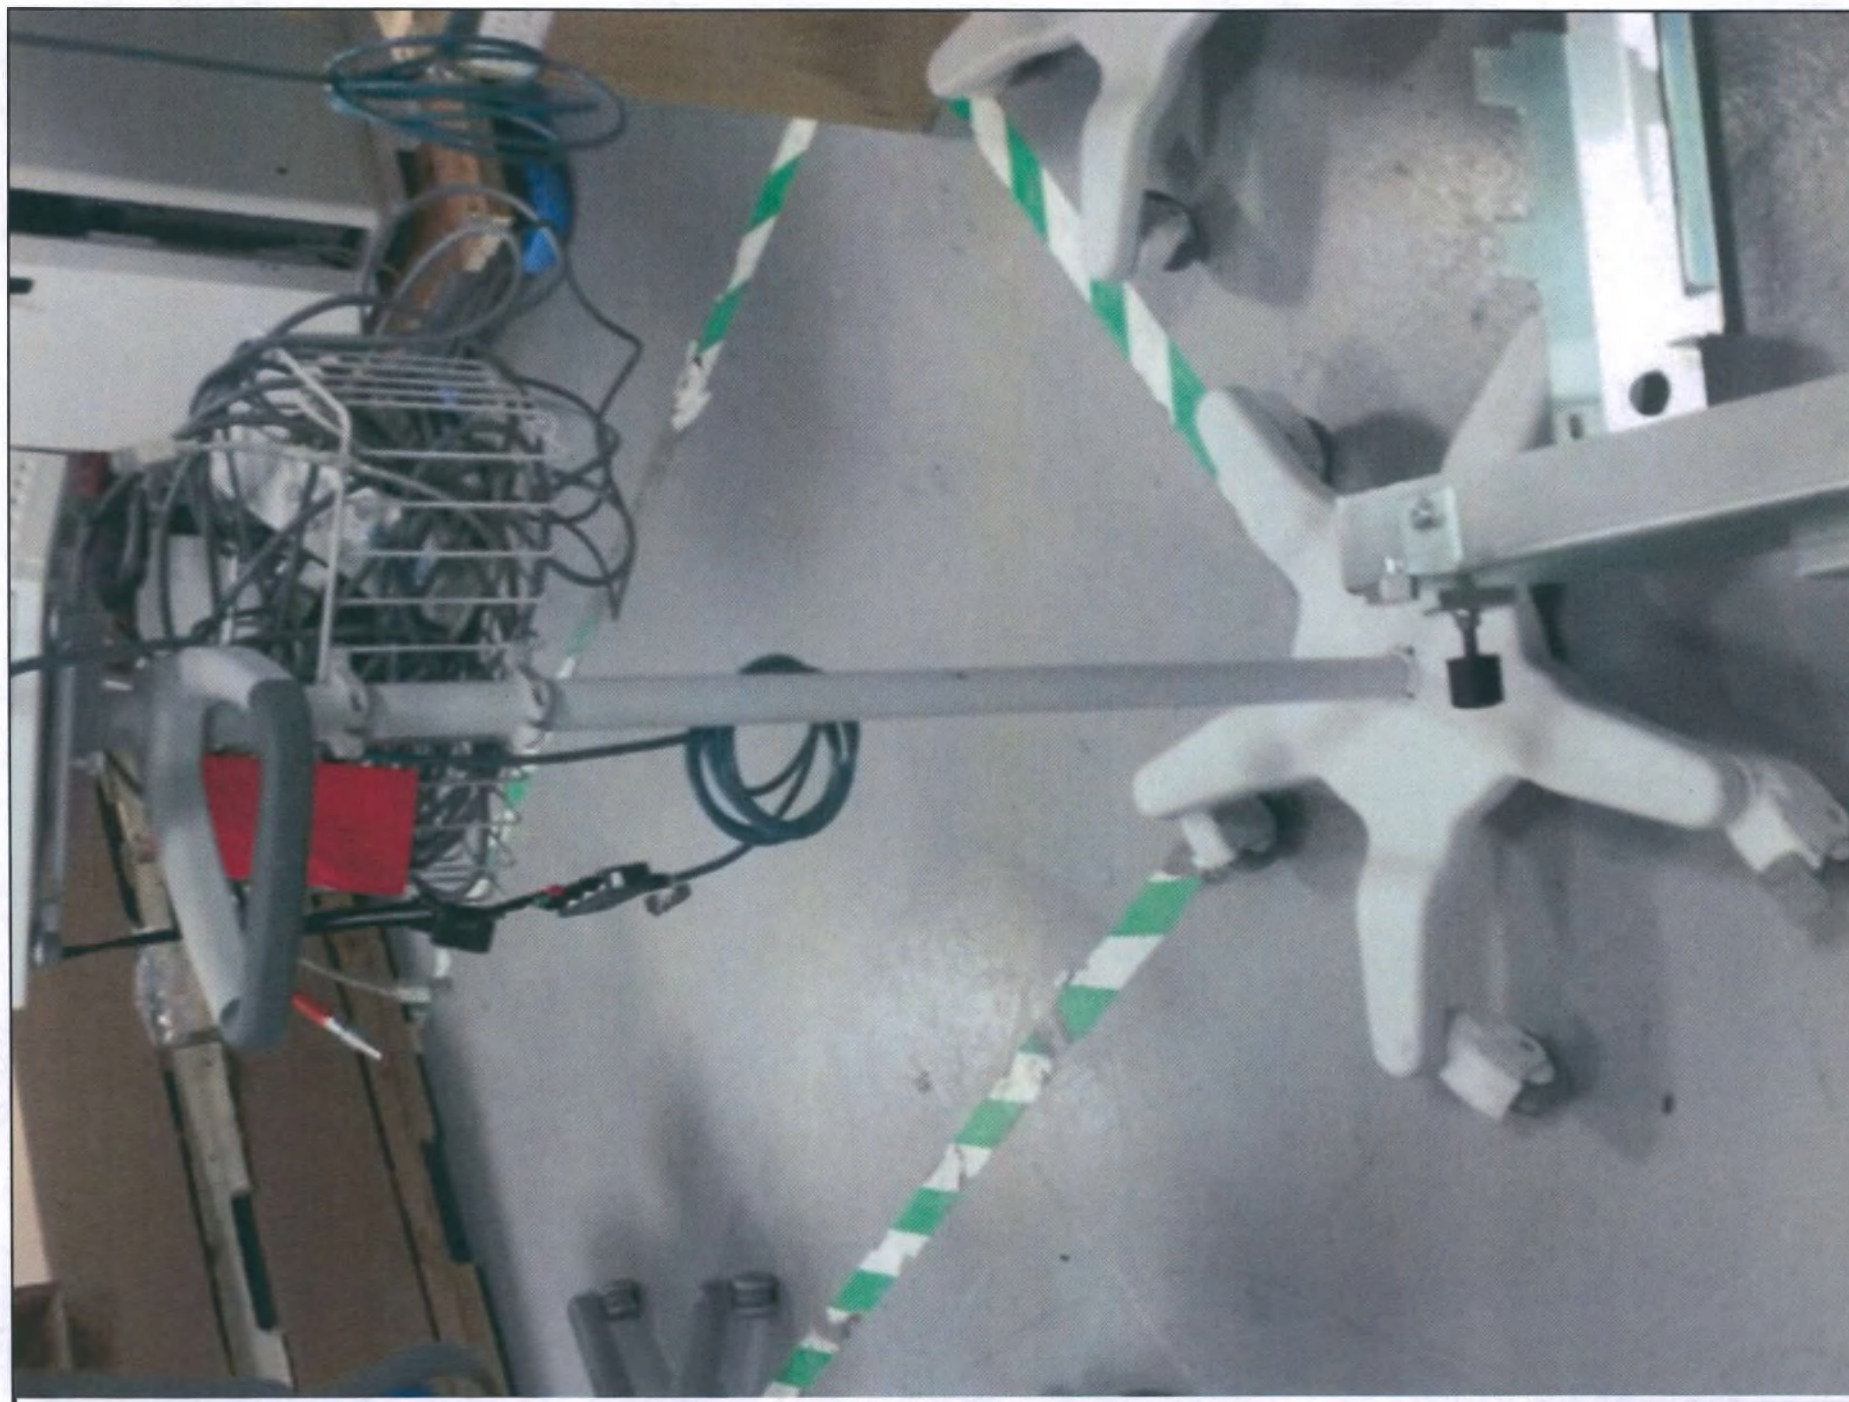

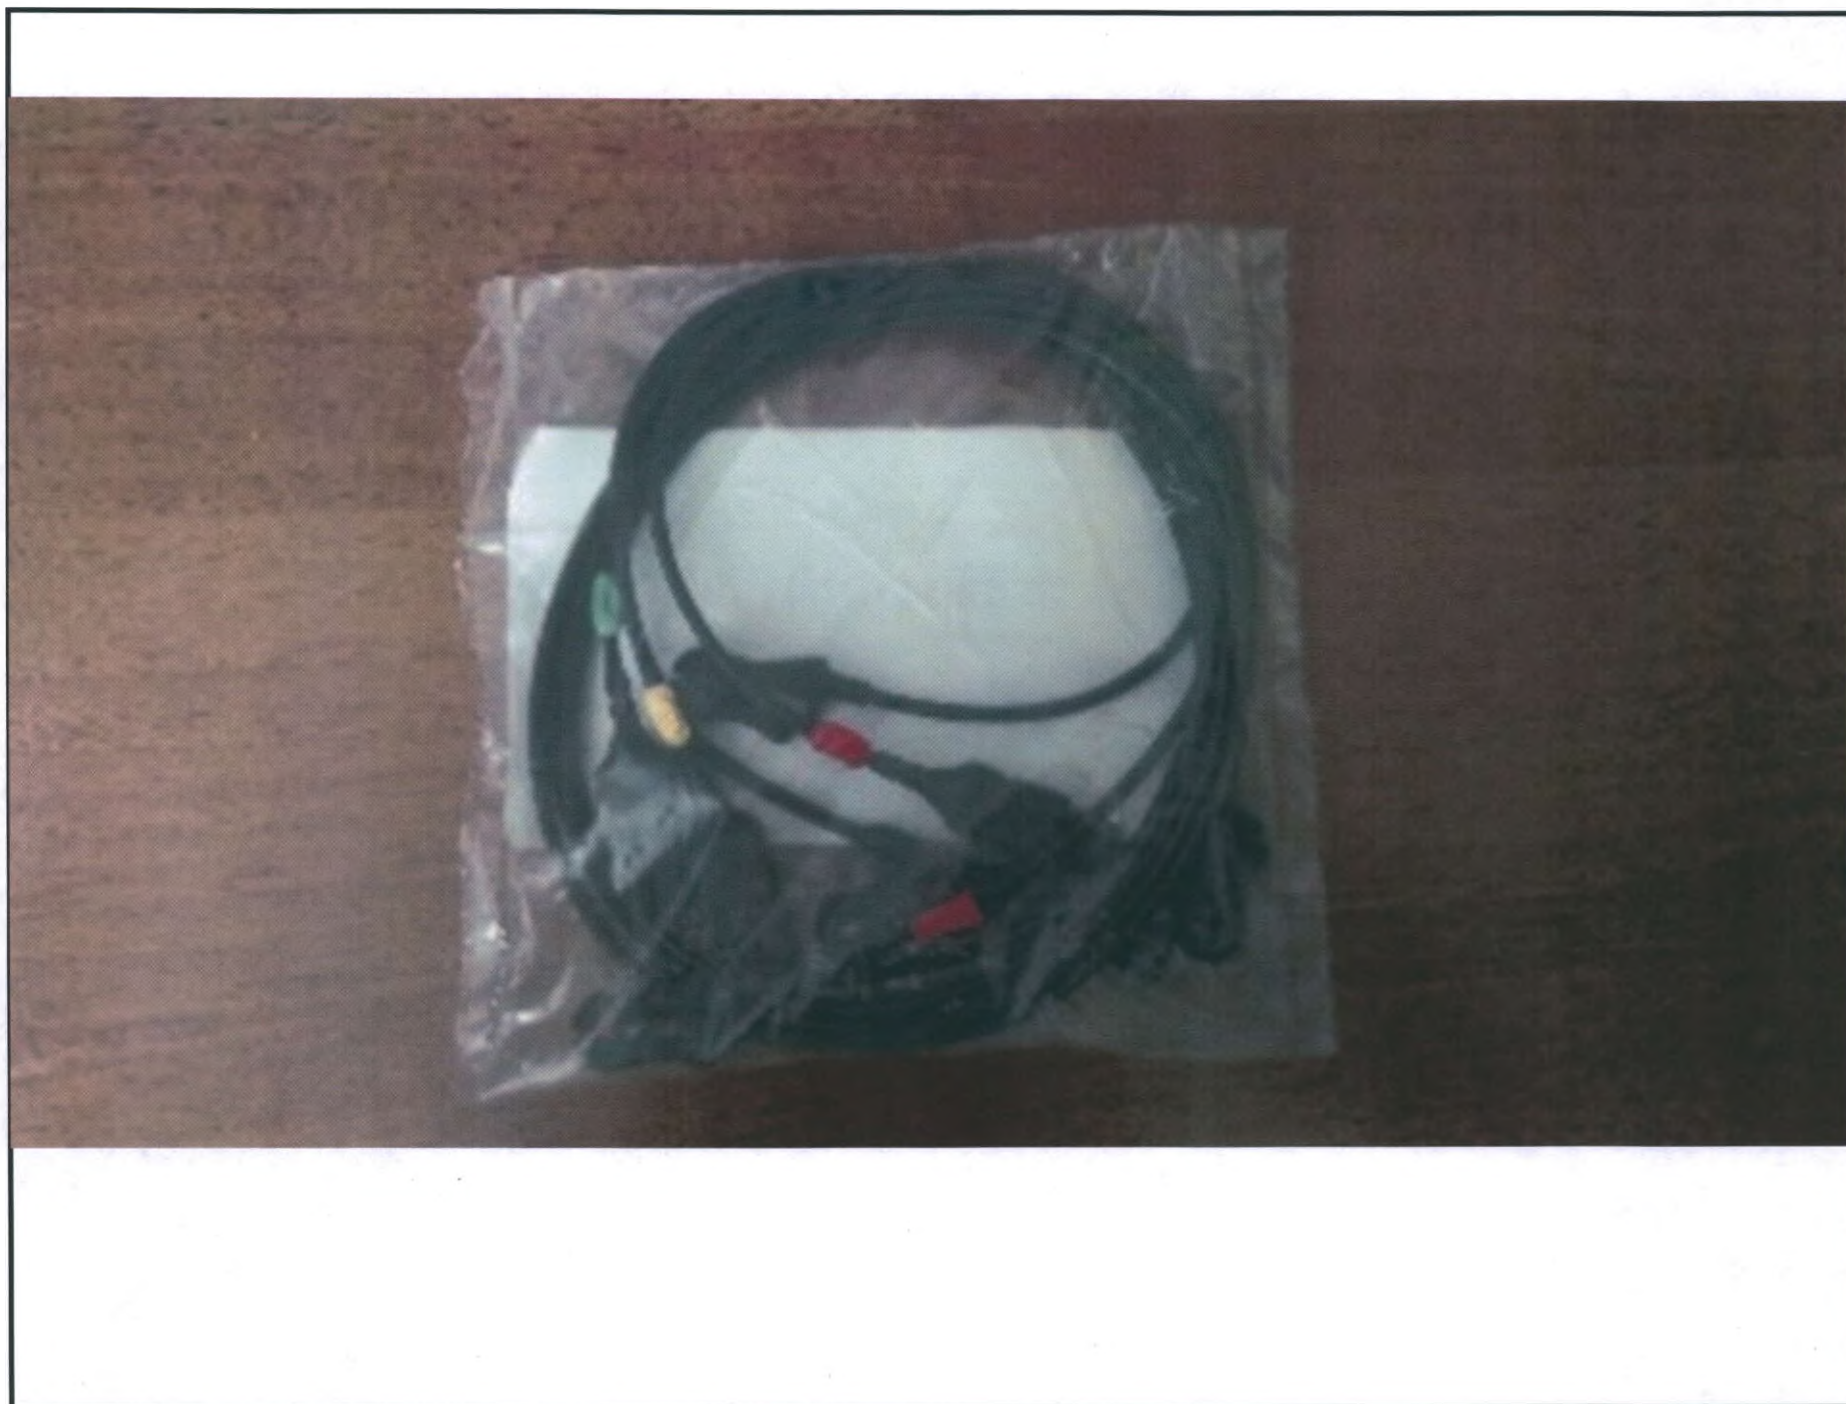














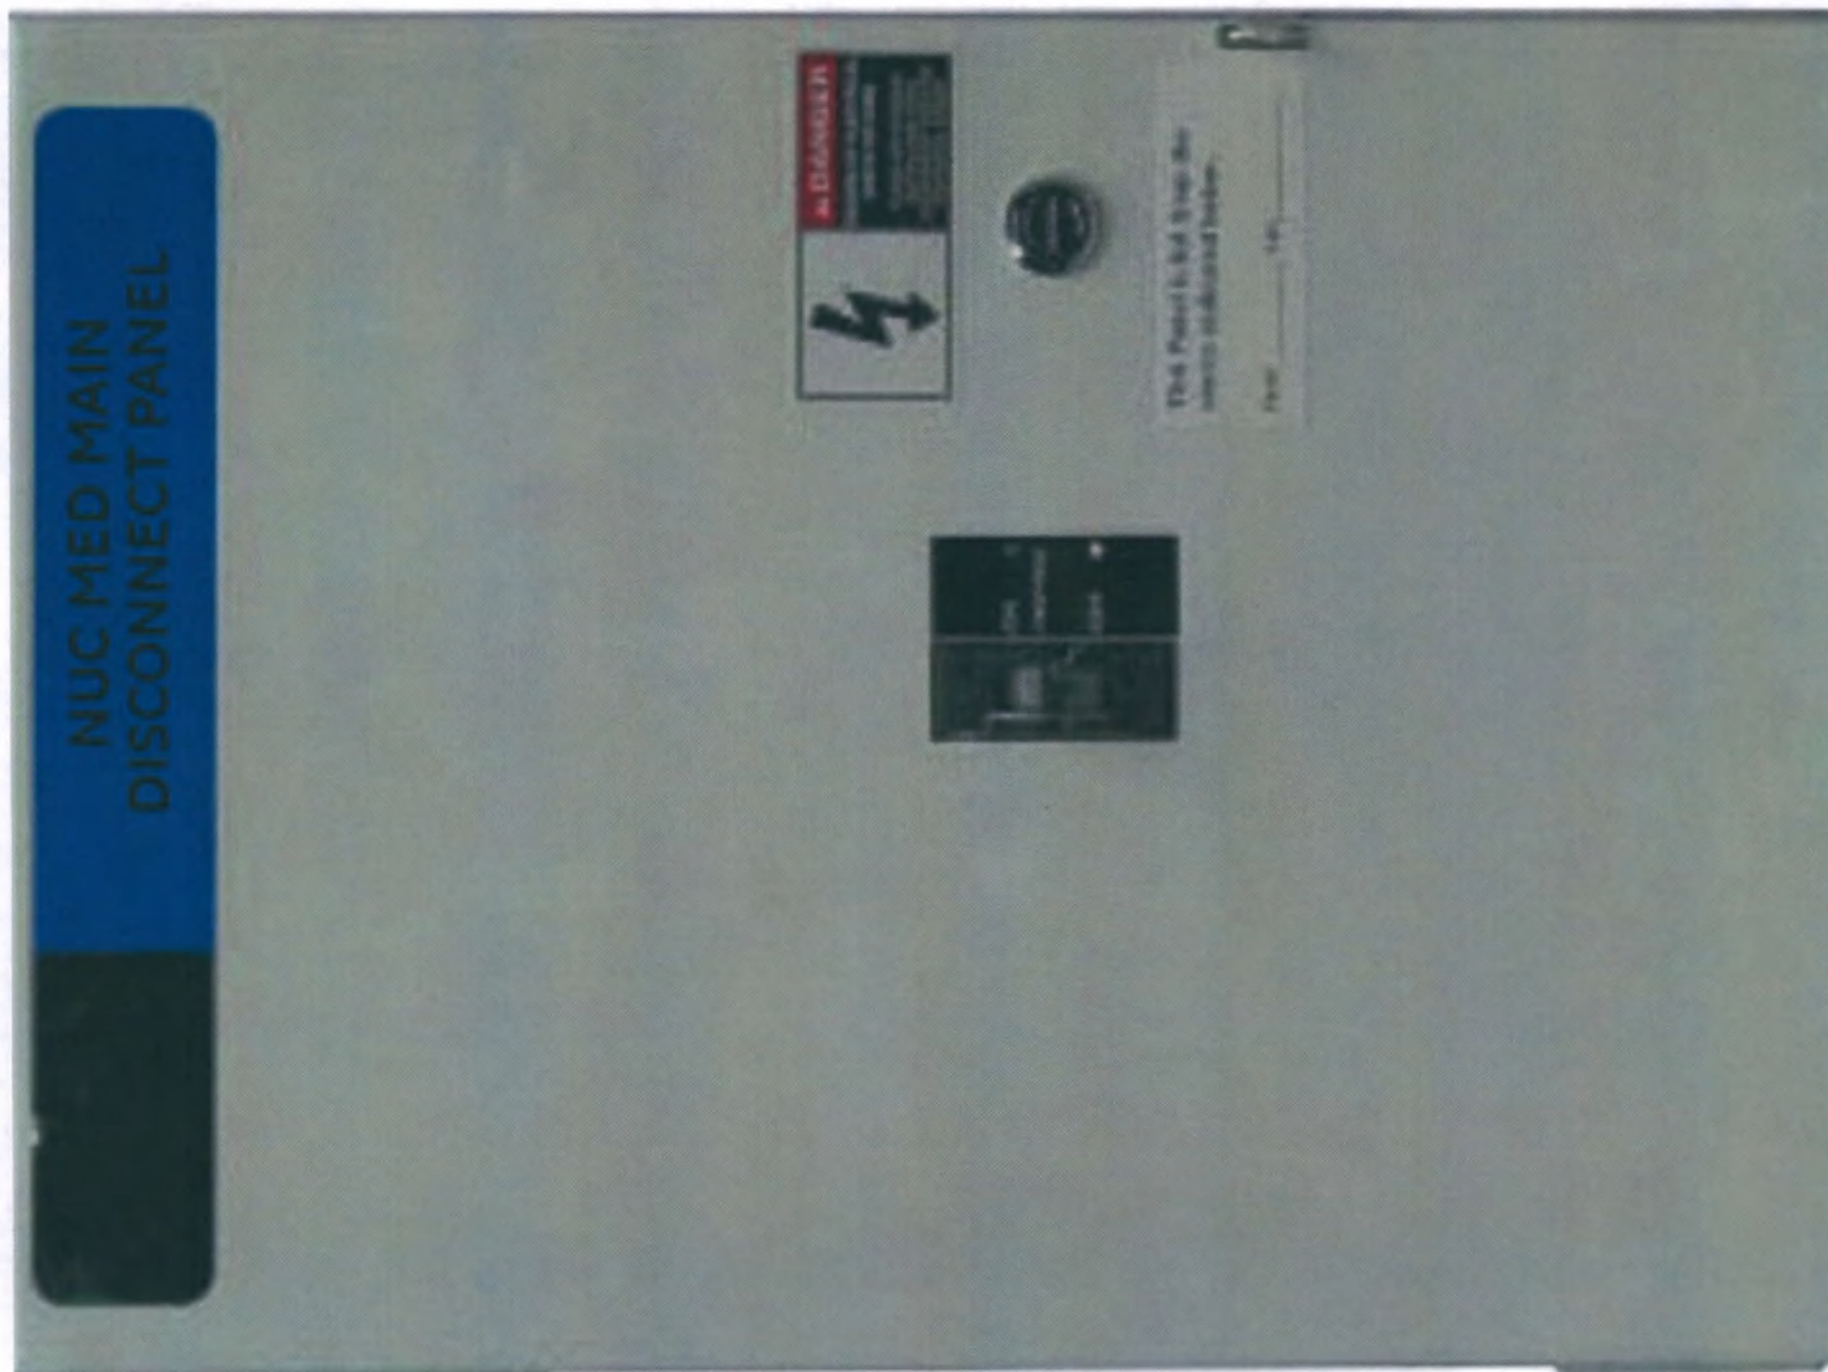














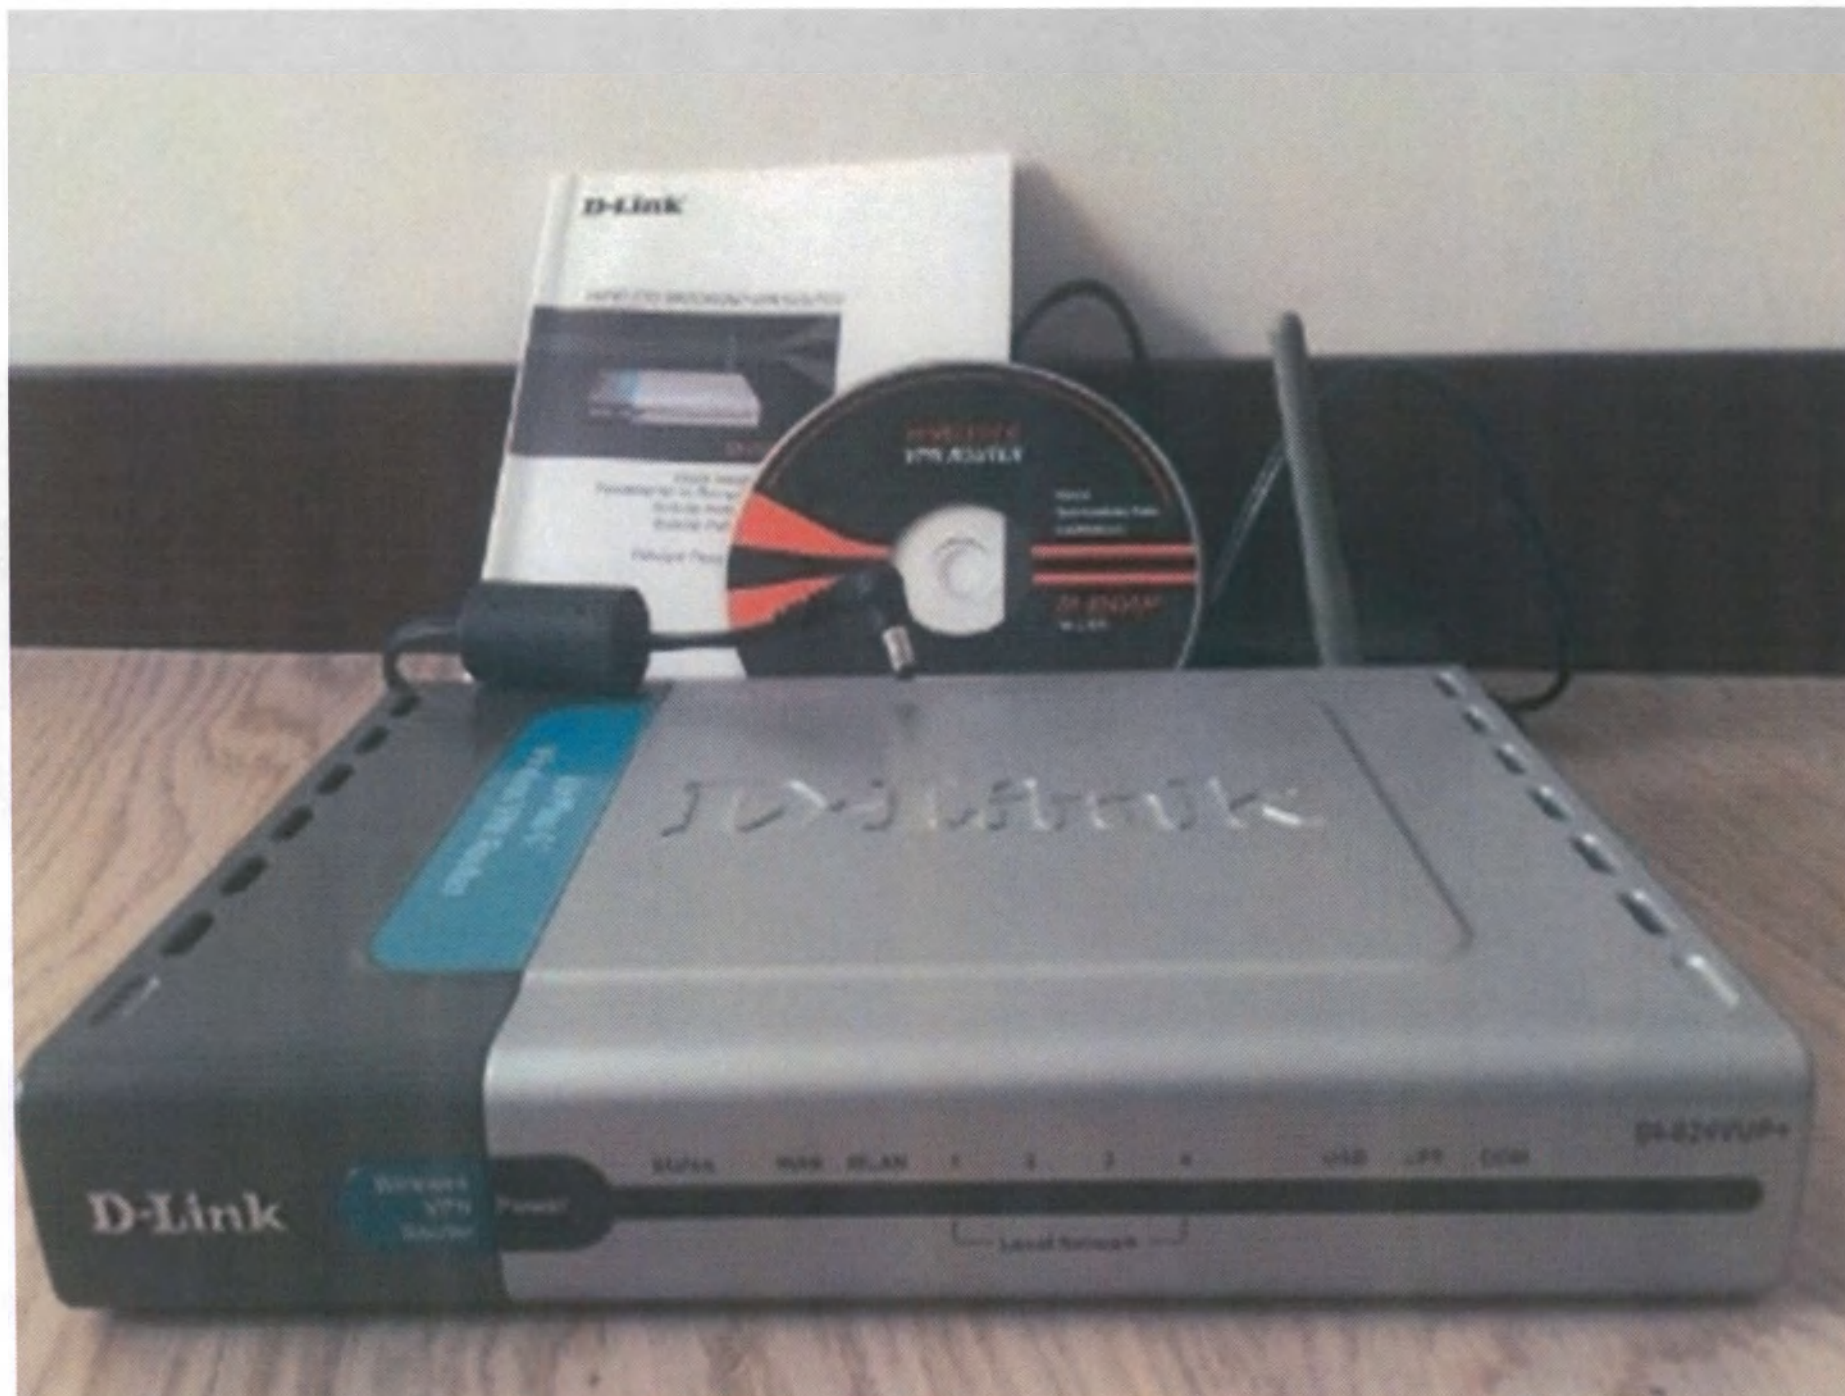





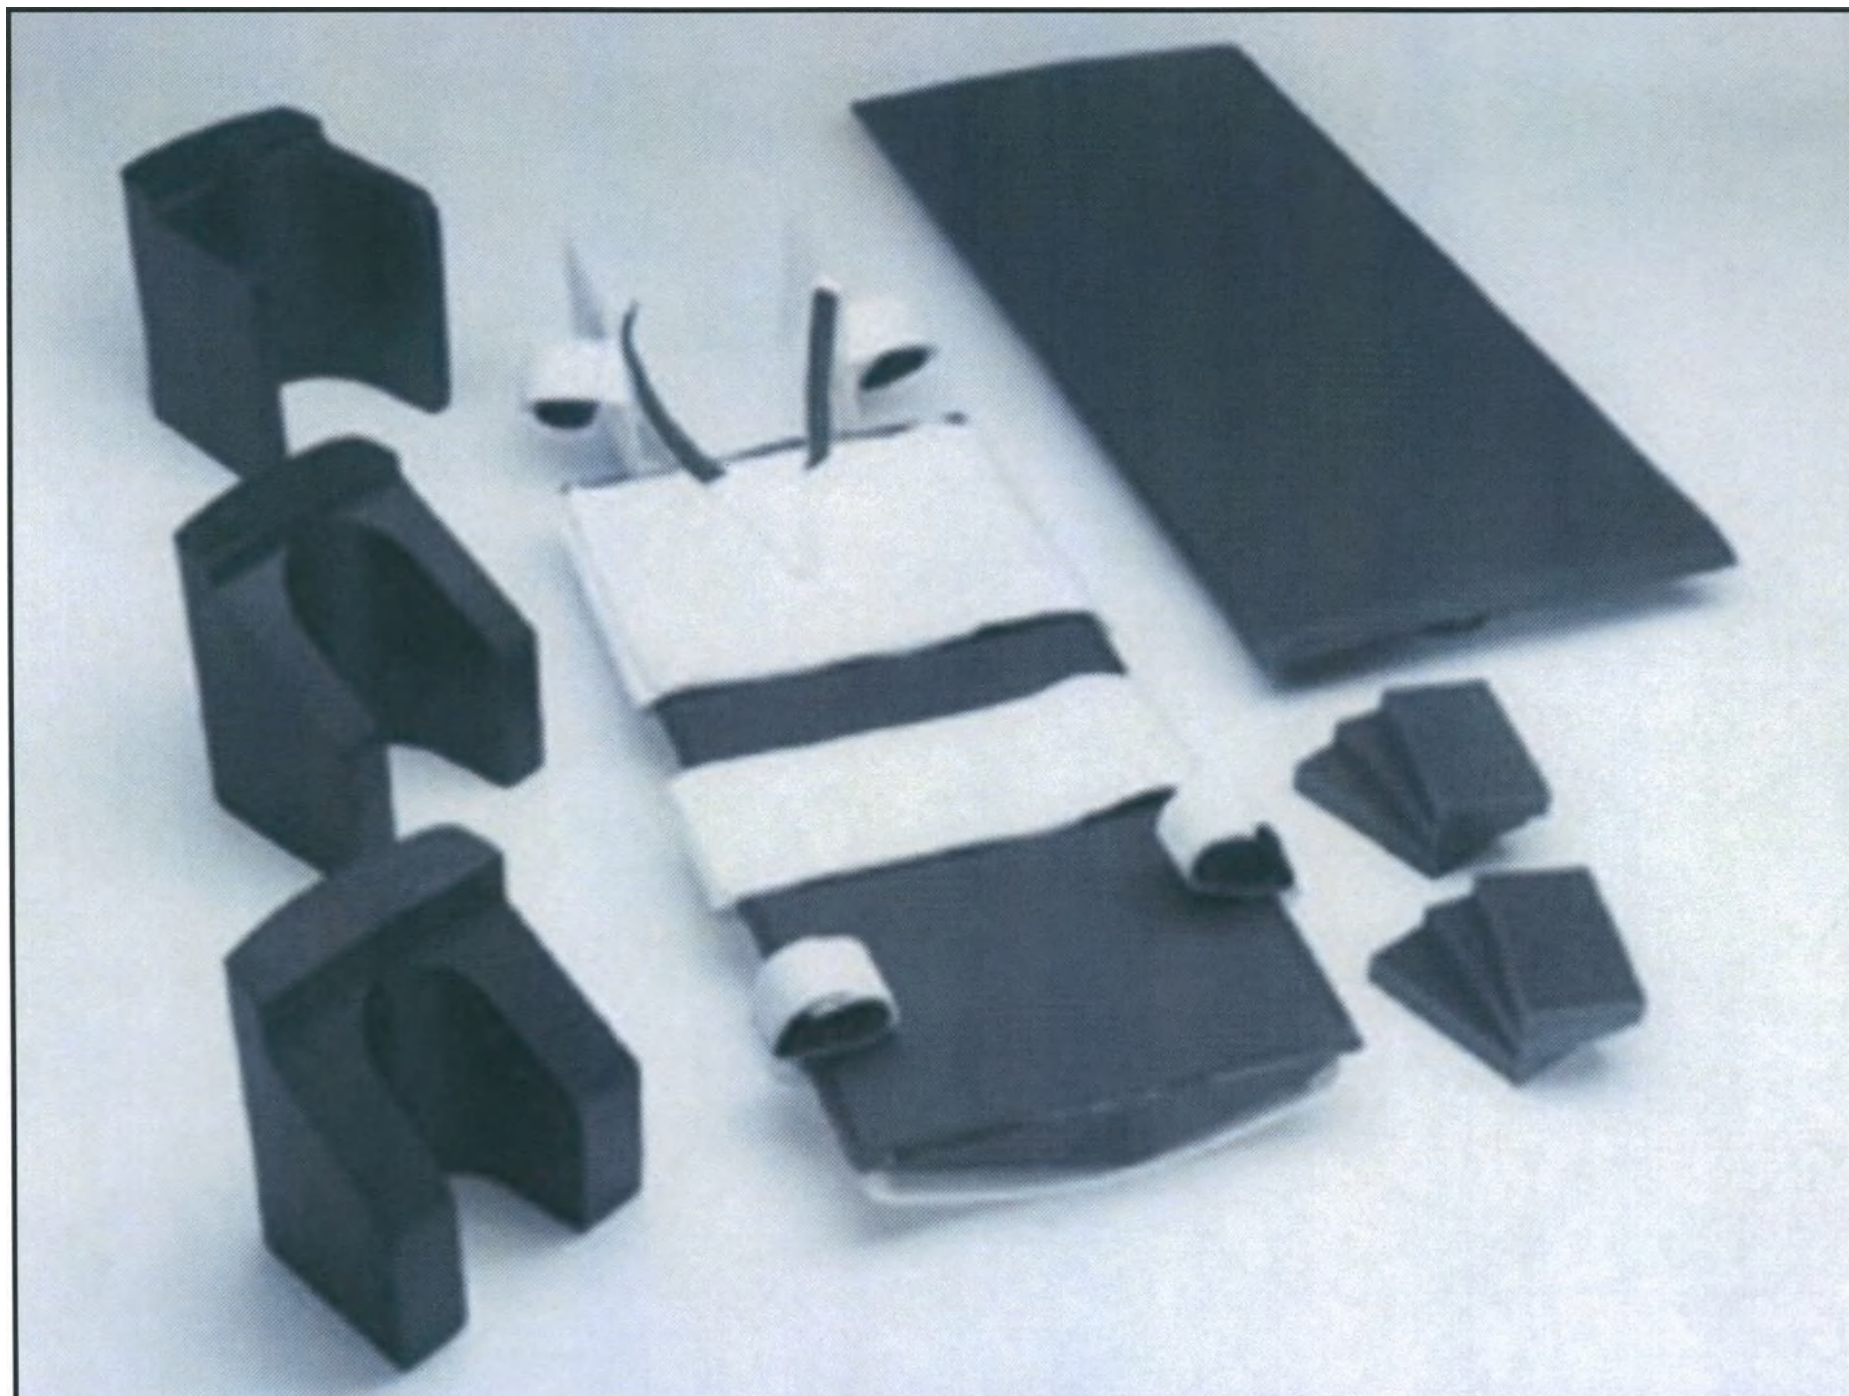

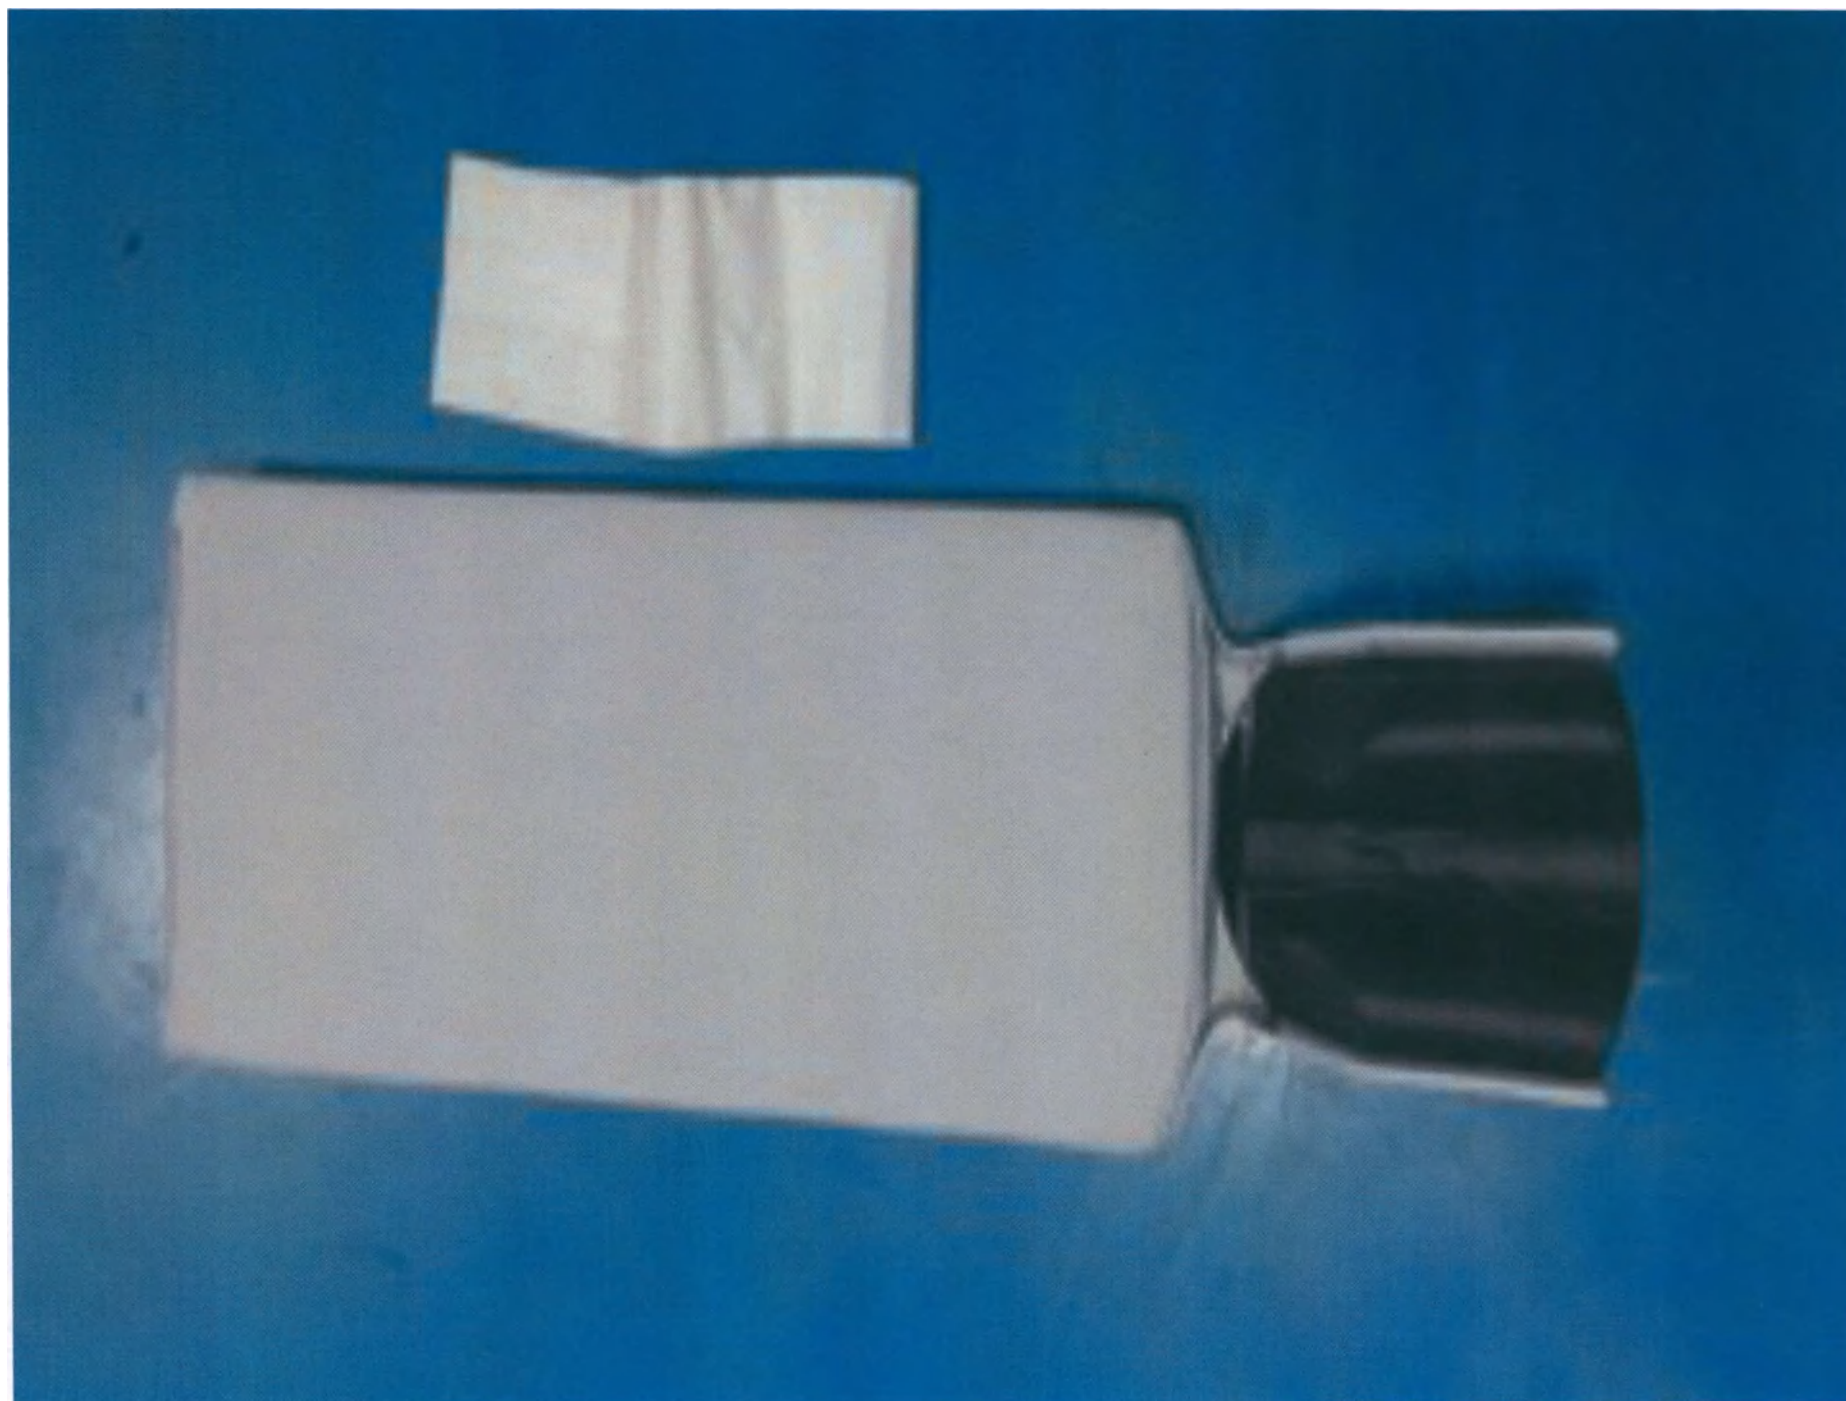











Набор предохранительных ремней для позиционирования рук - Универсальные ремни для фиксации рук, - Ремни для сканирования с руками над головой . (для вариантов исполнения **Discovery NM 630** и **NM 830**)



Набор предохранительных ремней для позиционирования рук - Универсальные ремни для фиксации рук, - Ремни для сканирования с руками над головой. (для вариантов исполнения **Discovery NM 630** и **NM 830**)



Набор предохранительных ремней для позиционирования рук - Универсальные ремни для фиксации рук, - Ремни для сканирования с руками над головой. (для вариантов исполнения **Discovery NM 630** и **NM 830**)



Набор предохранительных ремней для позиционирования рук - Универсальные ремни для фиксации рук, - Ремни для сканирования с руками над головой. (для вариантов исполнения **Discovery NM 630** и **NM 830**)




Набор предохранительных ремней для позиционирования рук - Универсальные ремни для фиксации рук, - Ремни для сканирования с руками над головой. (для вариантов исполнения **Discovery NM 630** и **NM 830**)










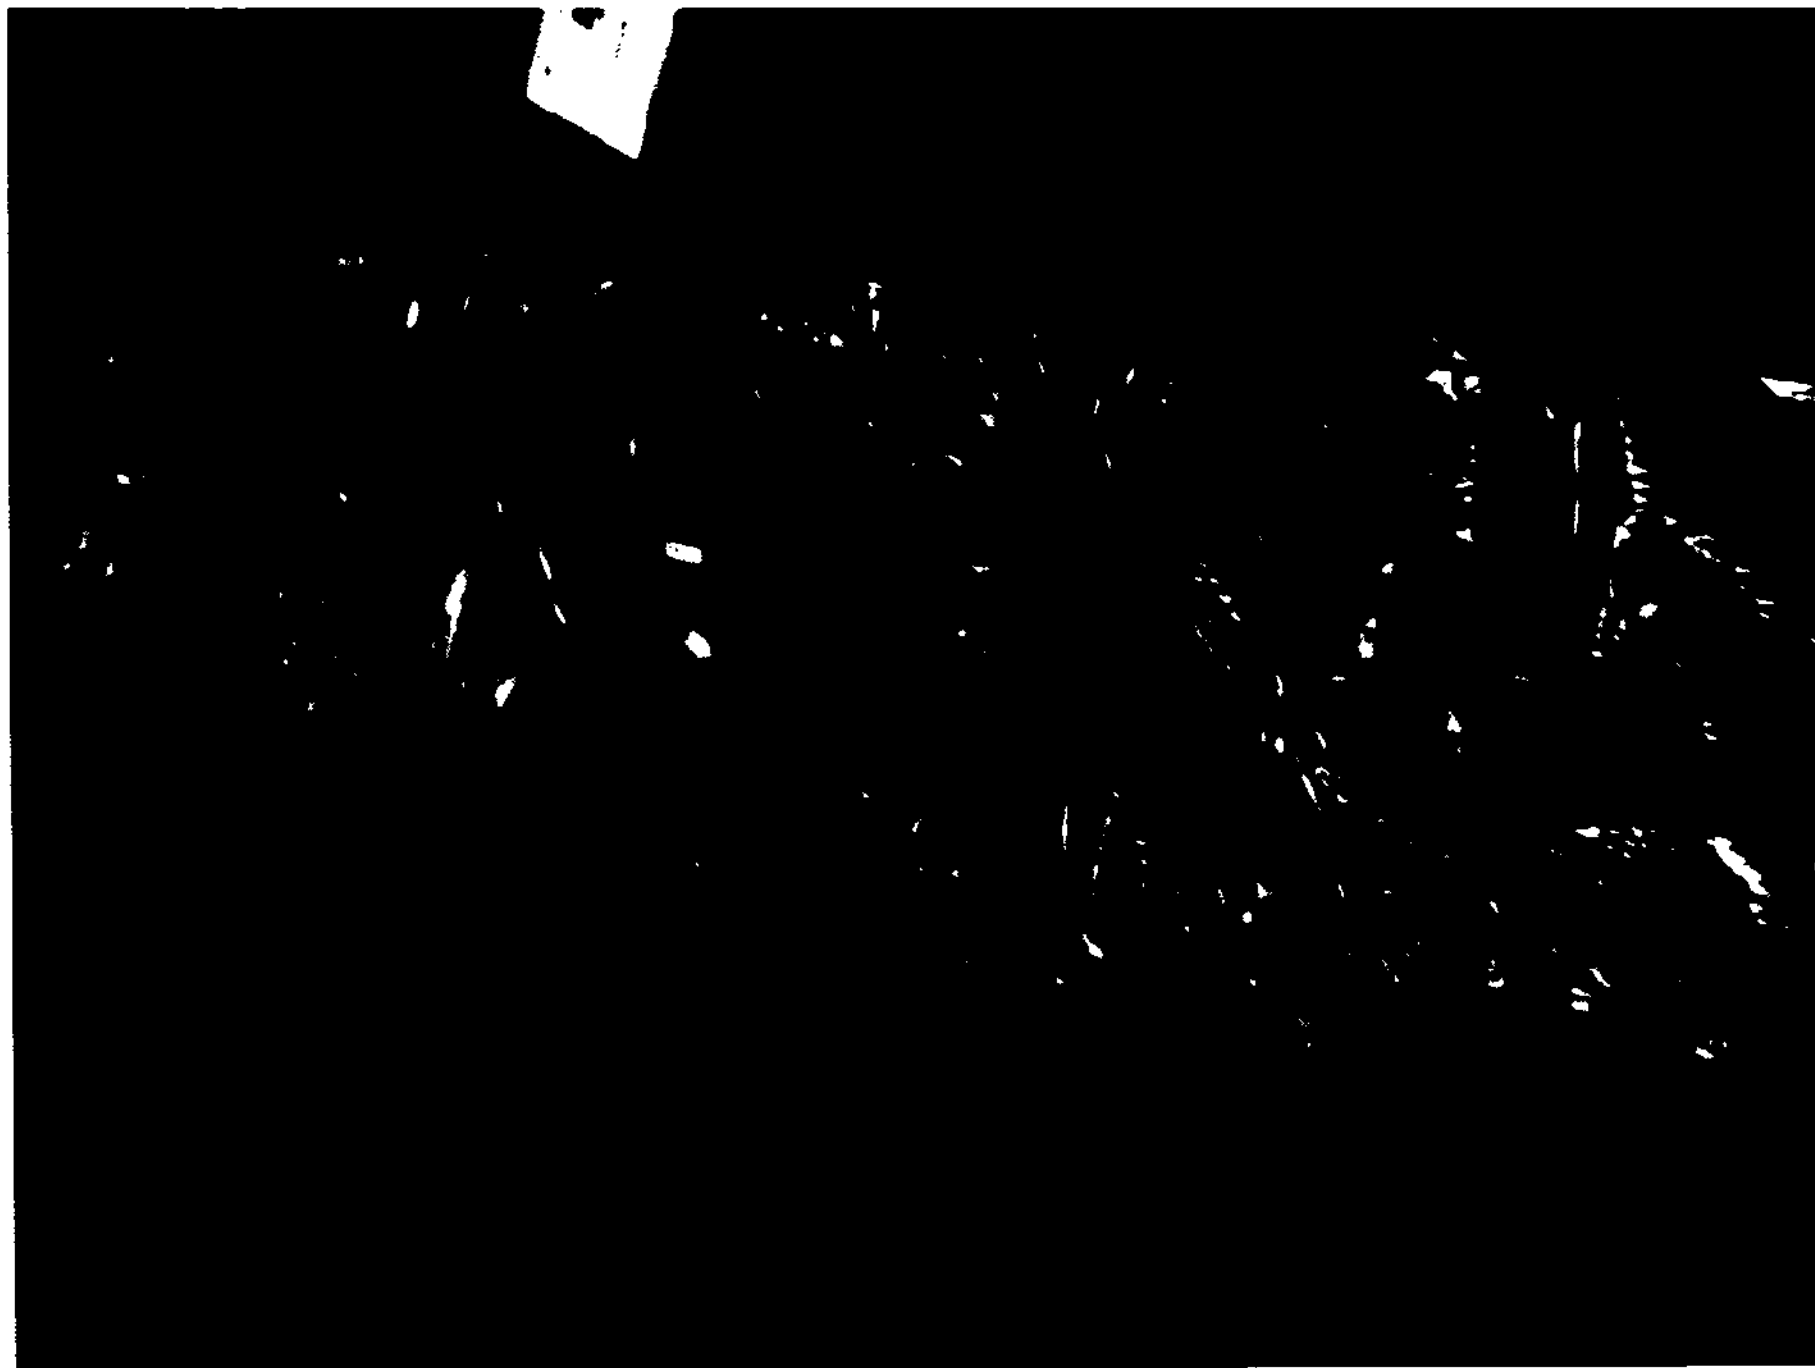


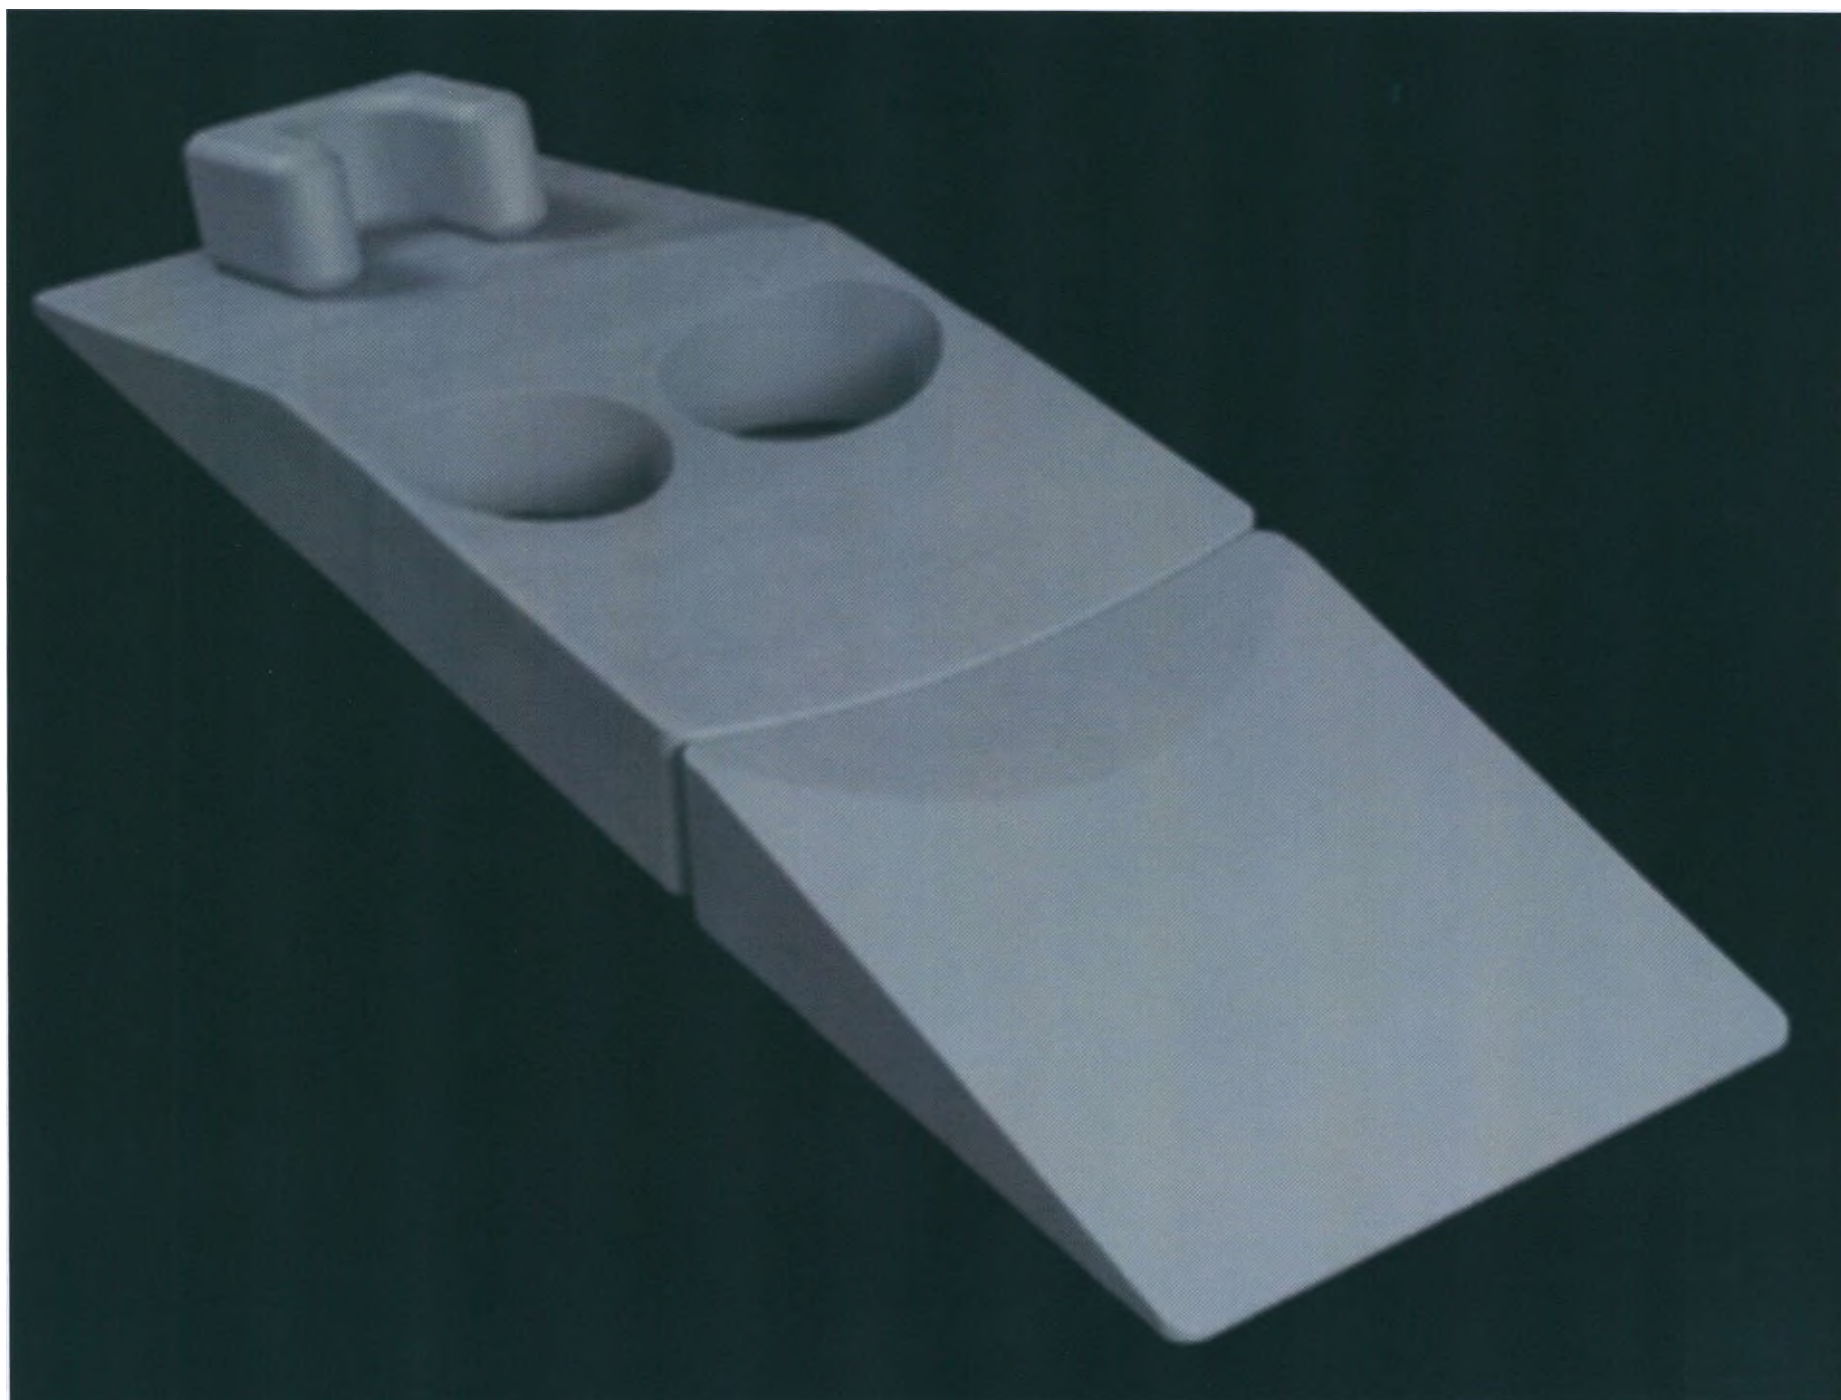








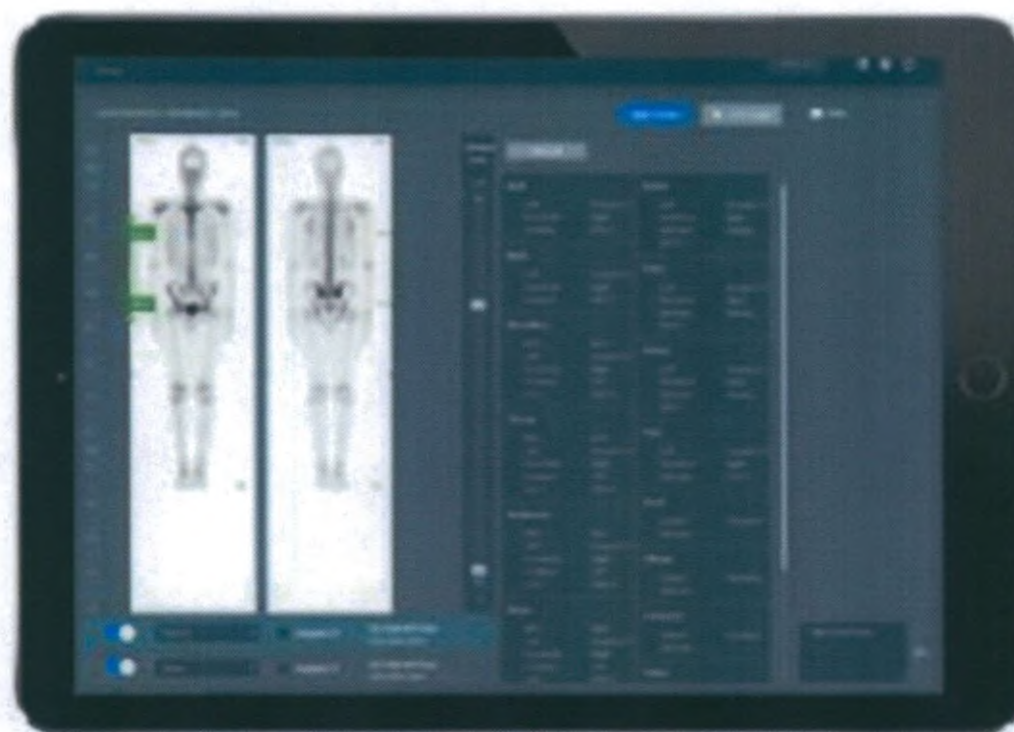


SmartConsole Web (у врача)




SmartConsole (у оператора)

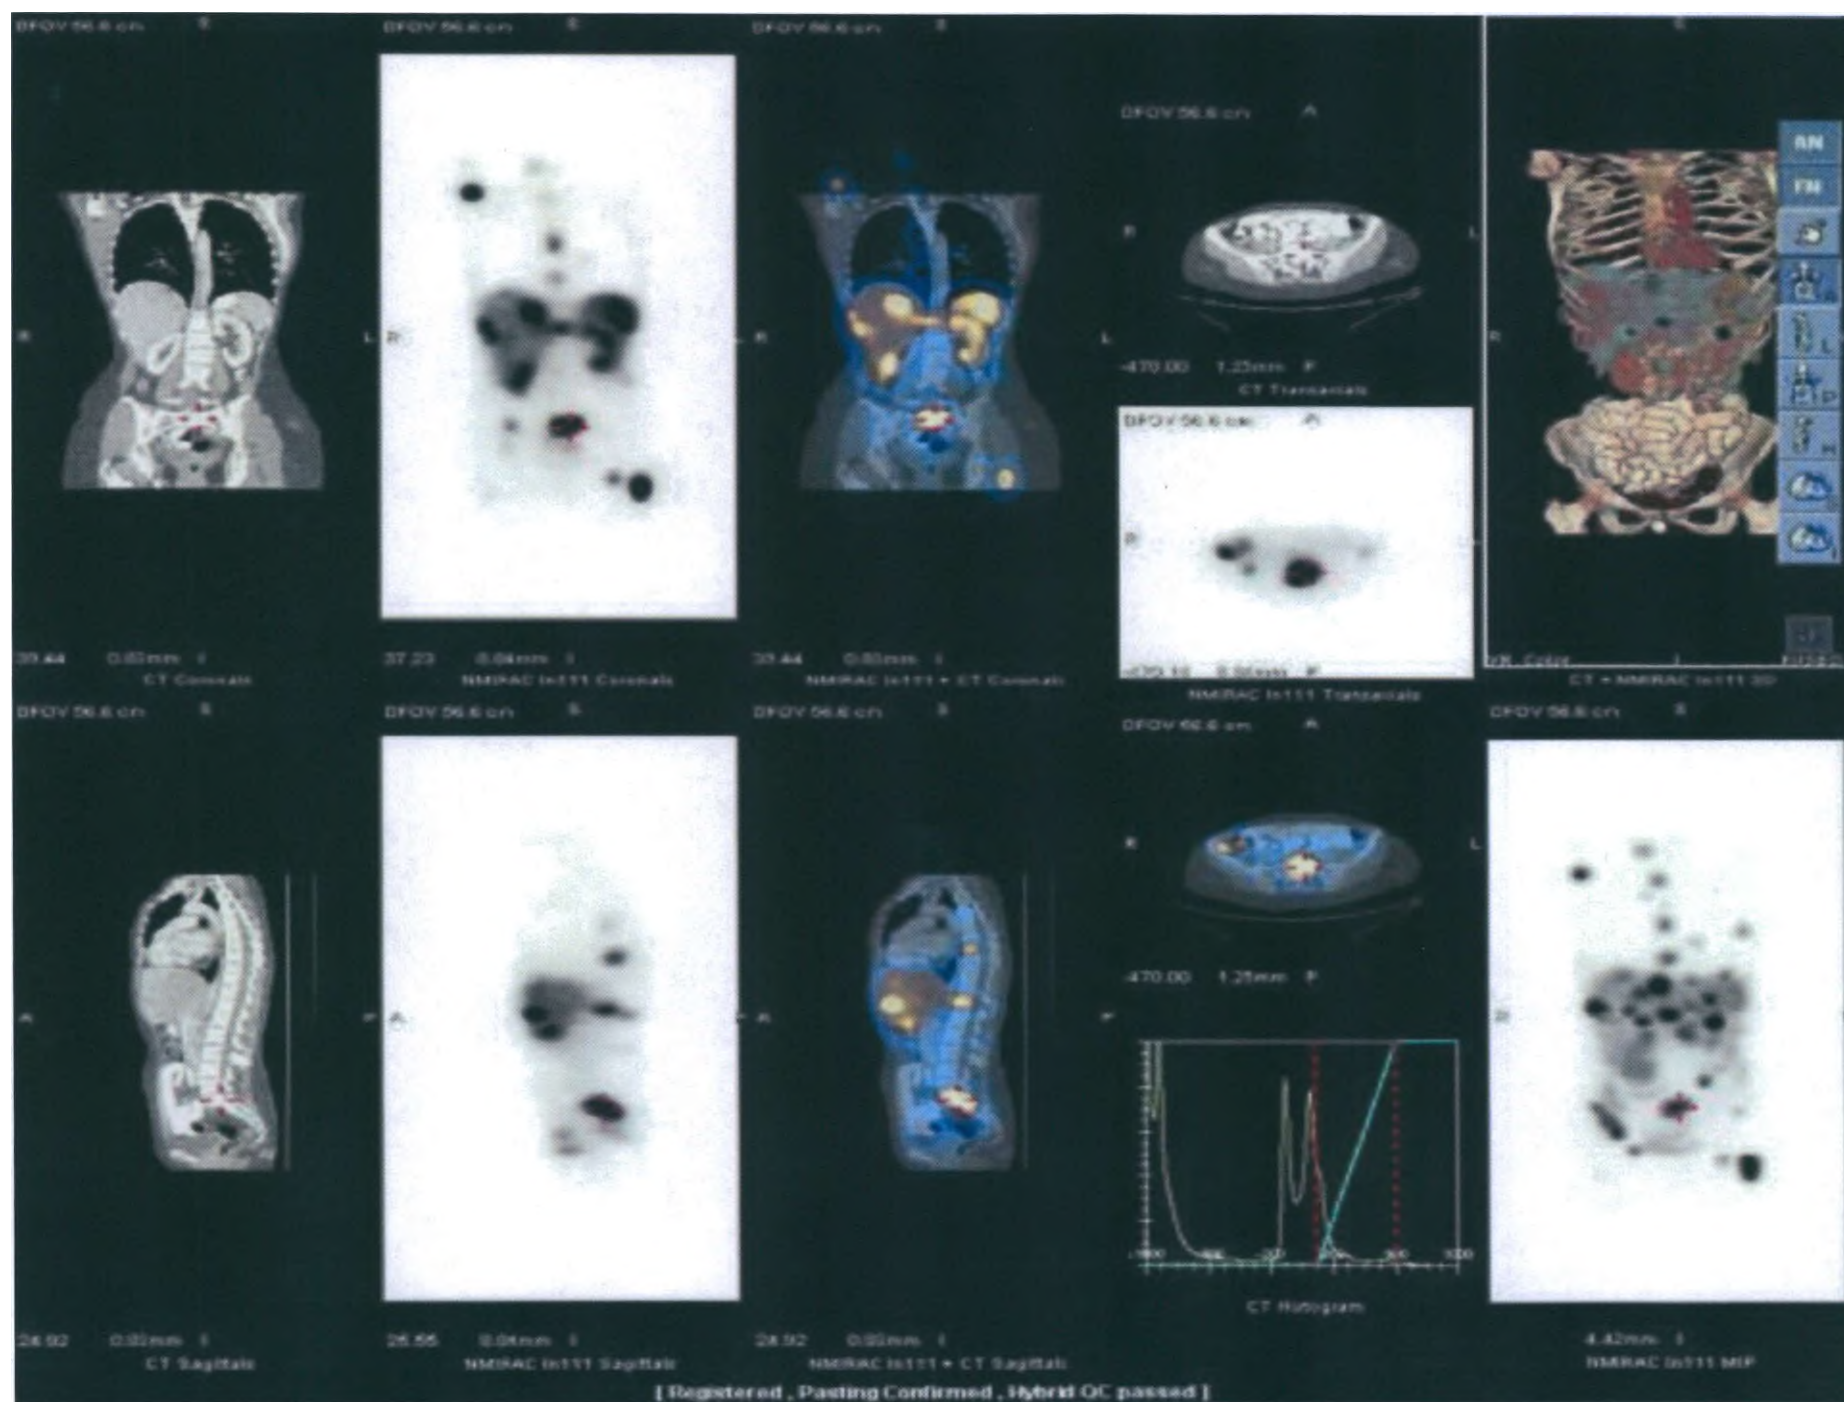



Программные пакеты для рабочей станции. (для вариантов исполнения **Discovery NM 630** и **NM 830**)

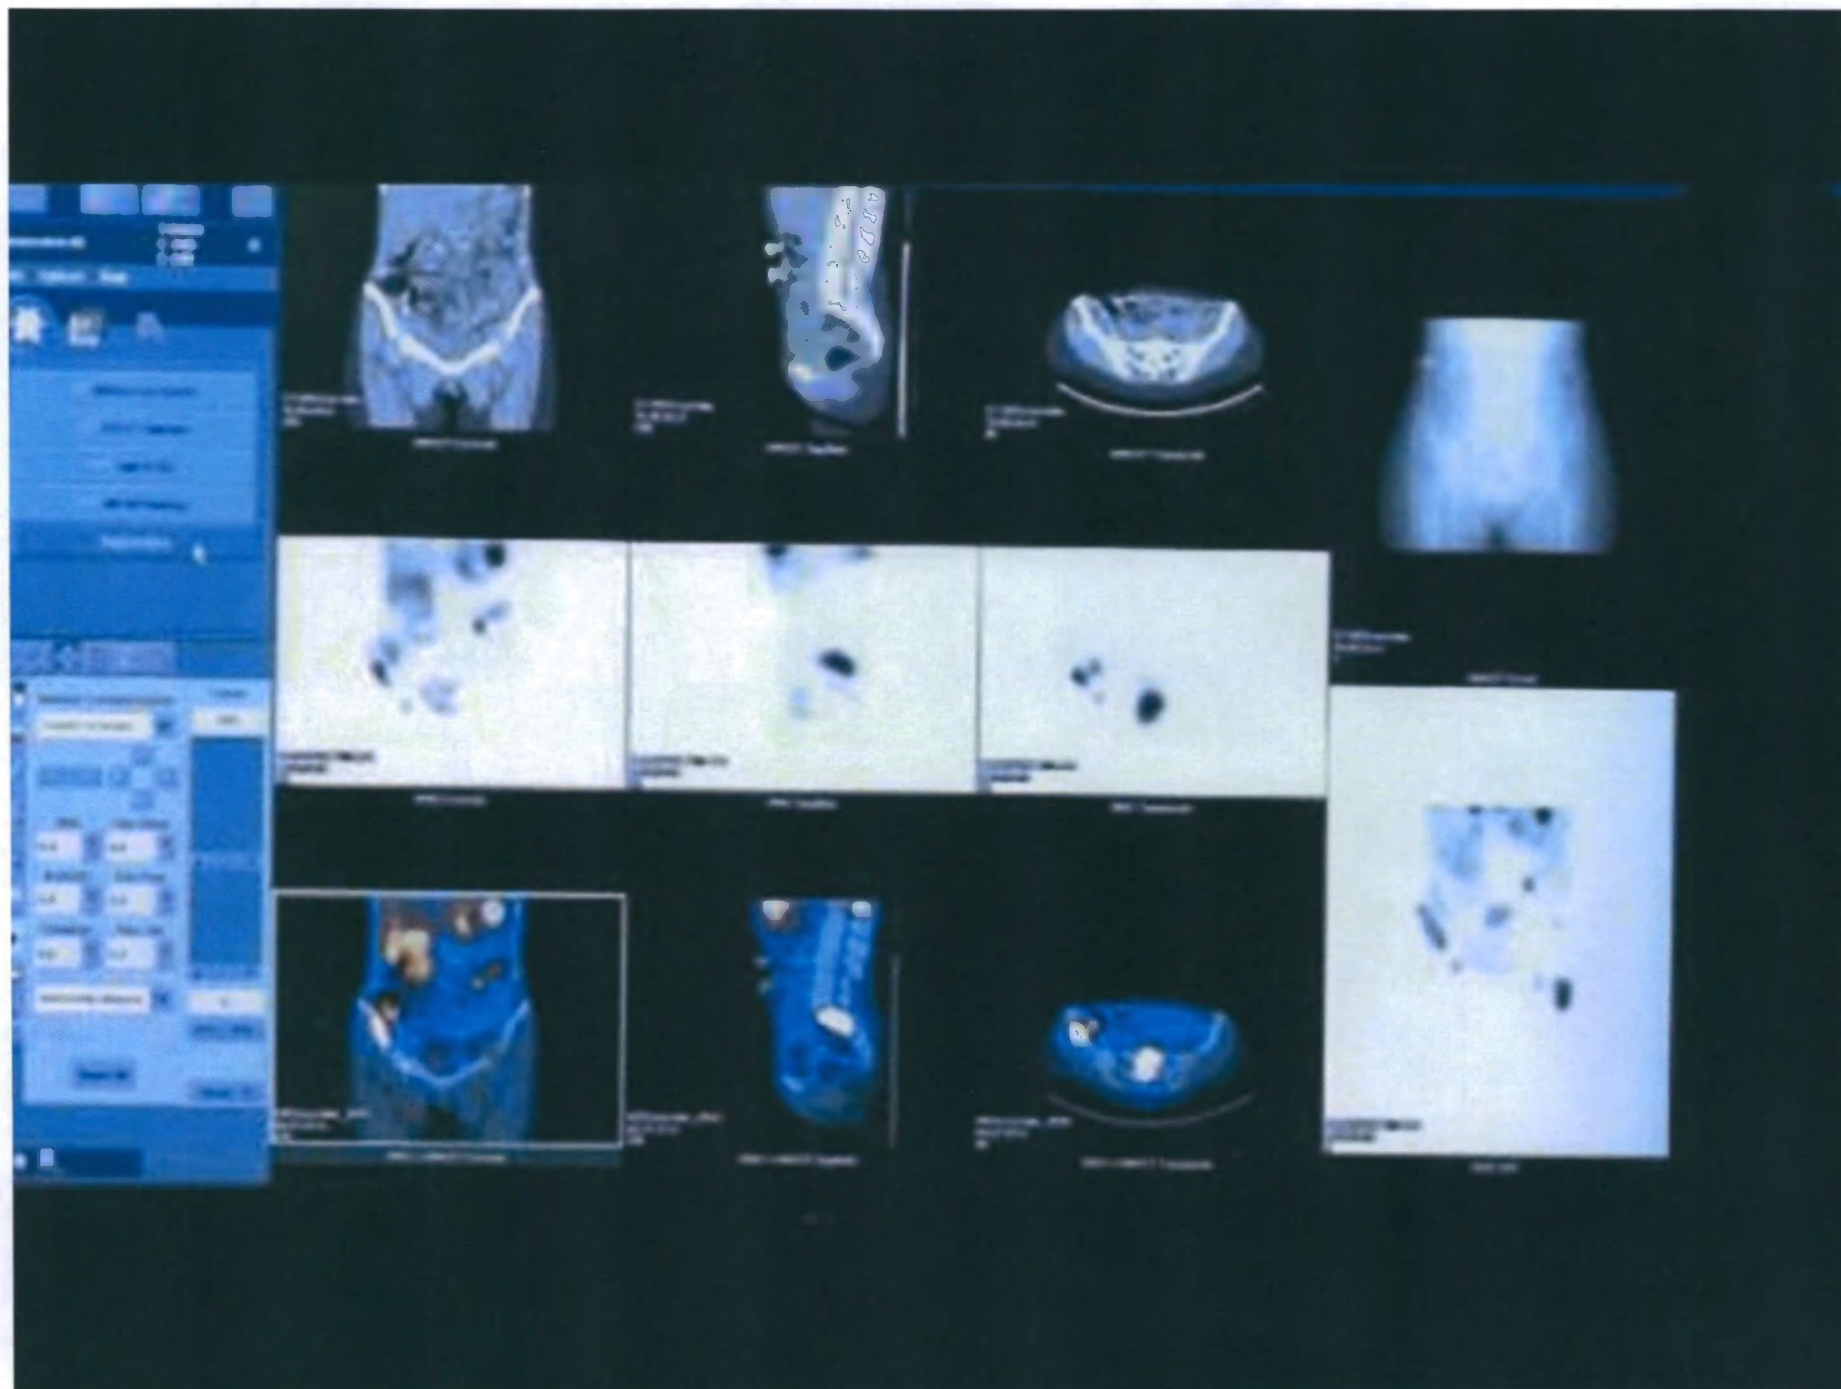


Программные пакеты для рабочей станции. (для вариантов исполнения **Discovery NM 630** и **NM 830**)



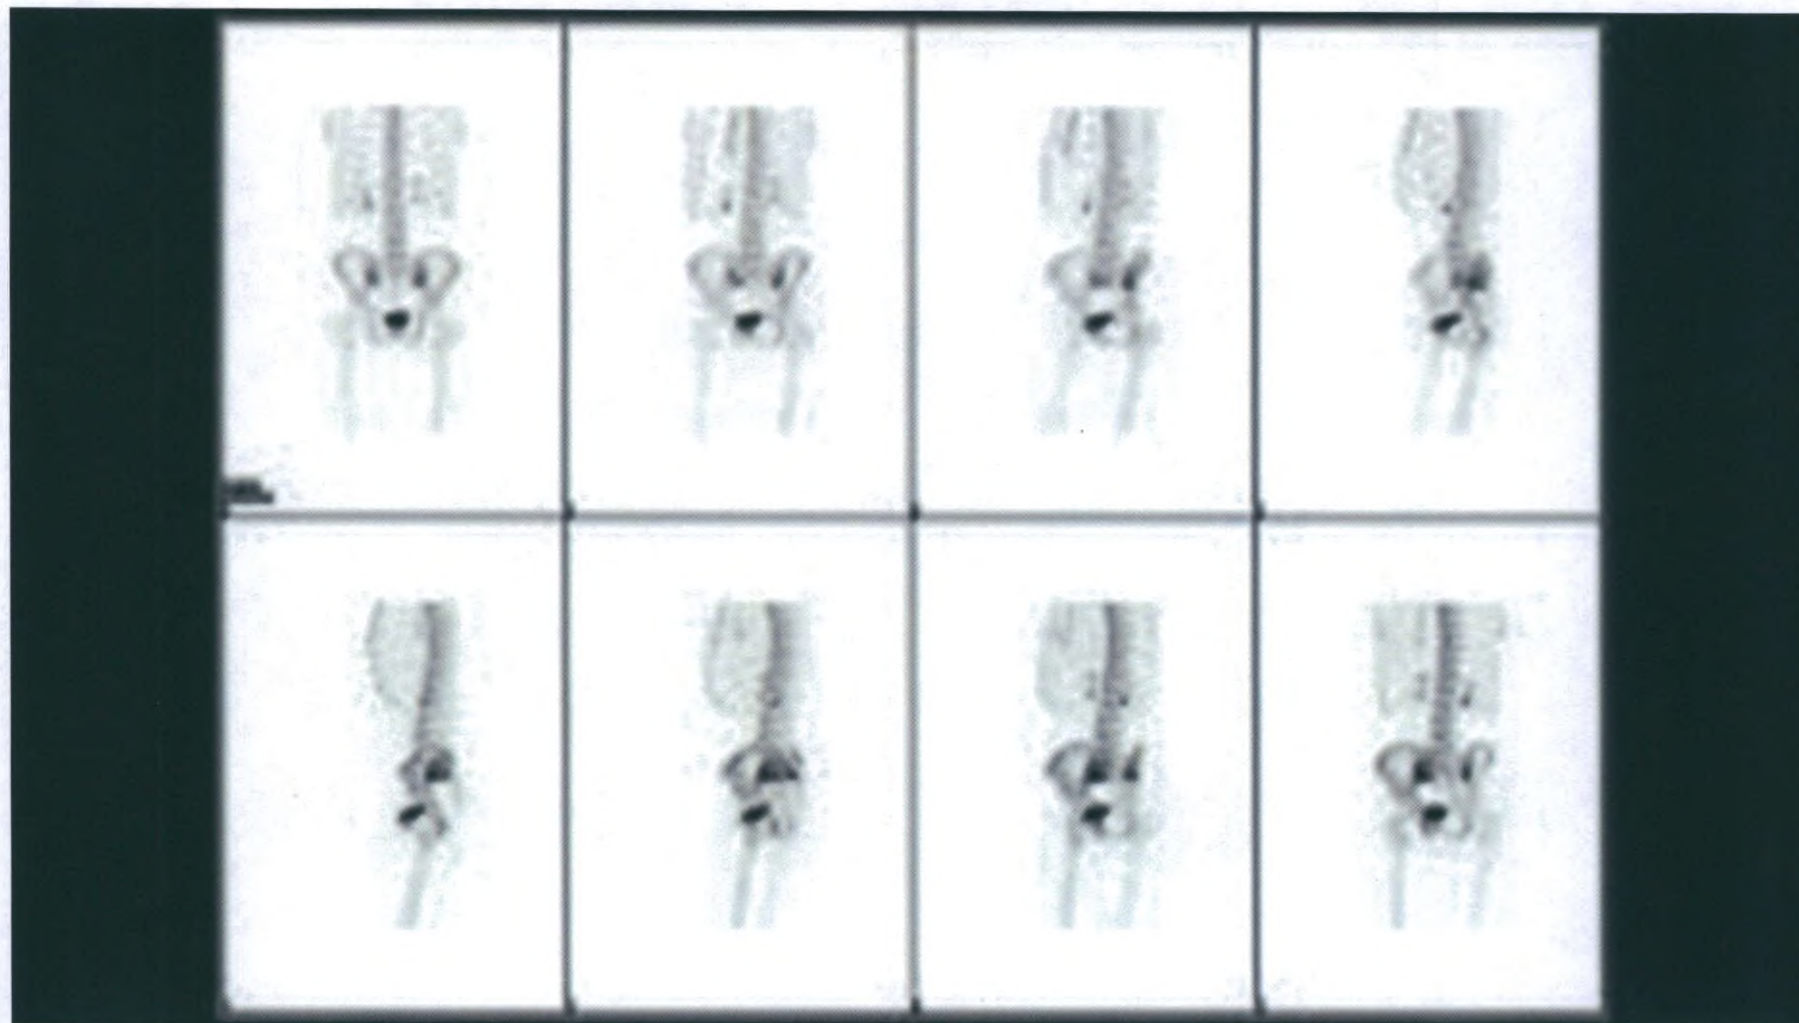


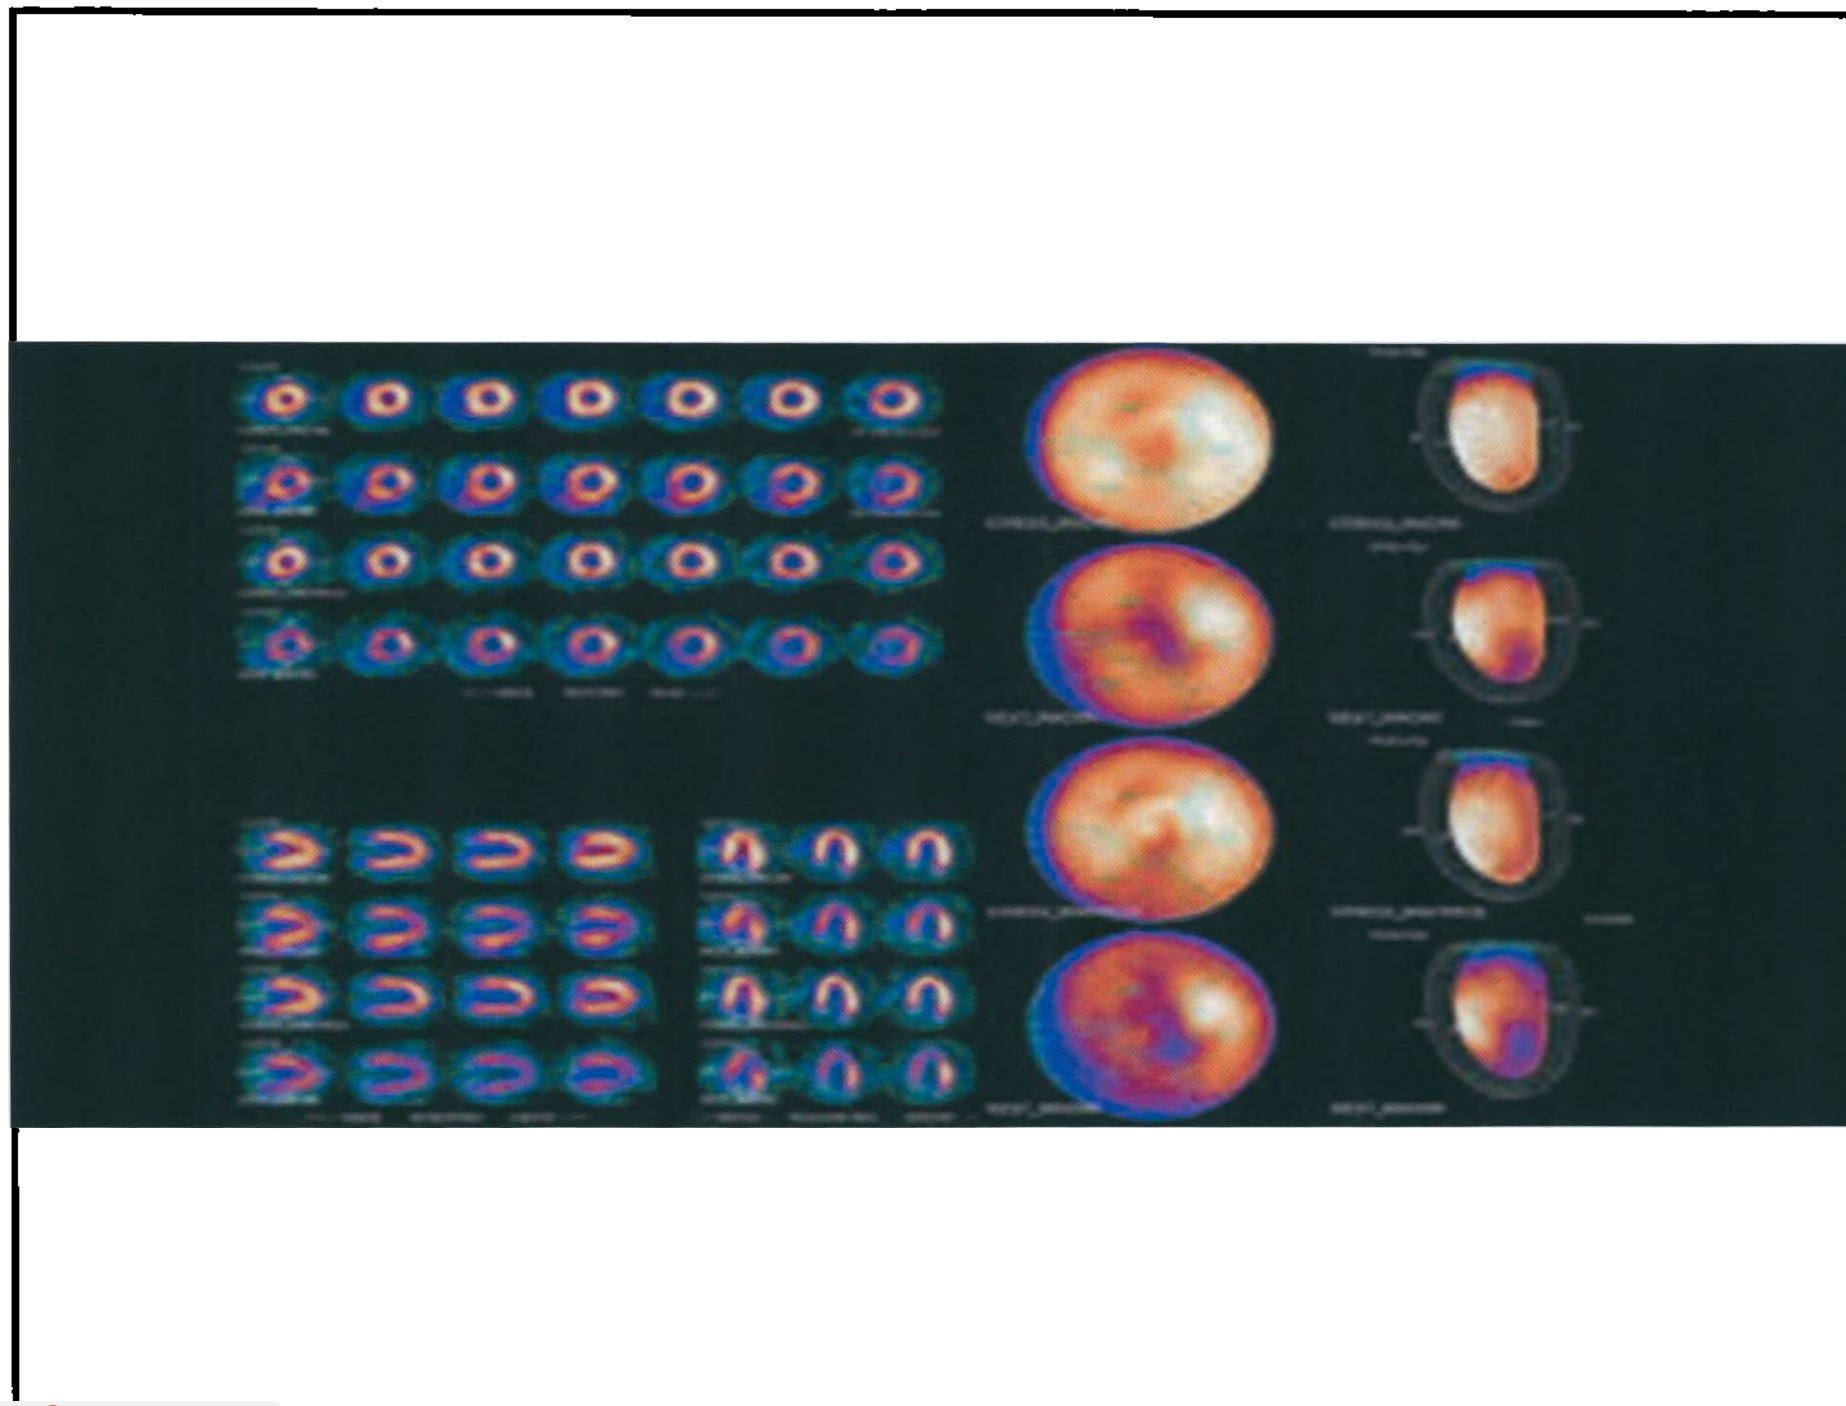


Программные пакеты для рабочей станции. (для вариантов исполнения **Discovery NM 630** и **NM 830**)

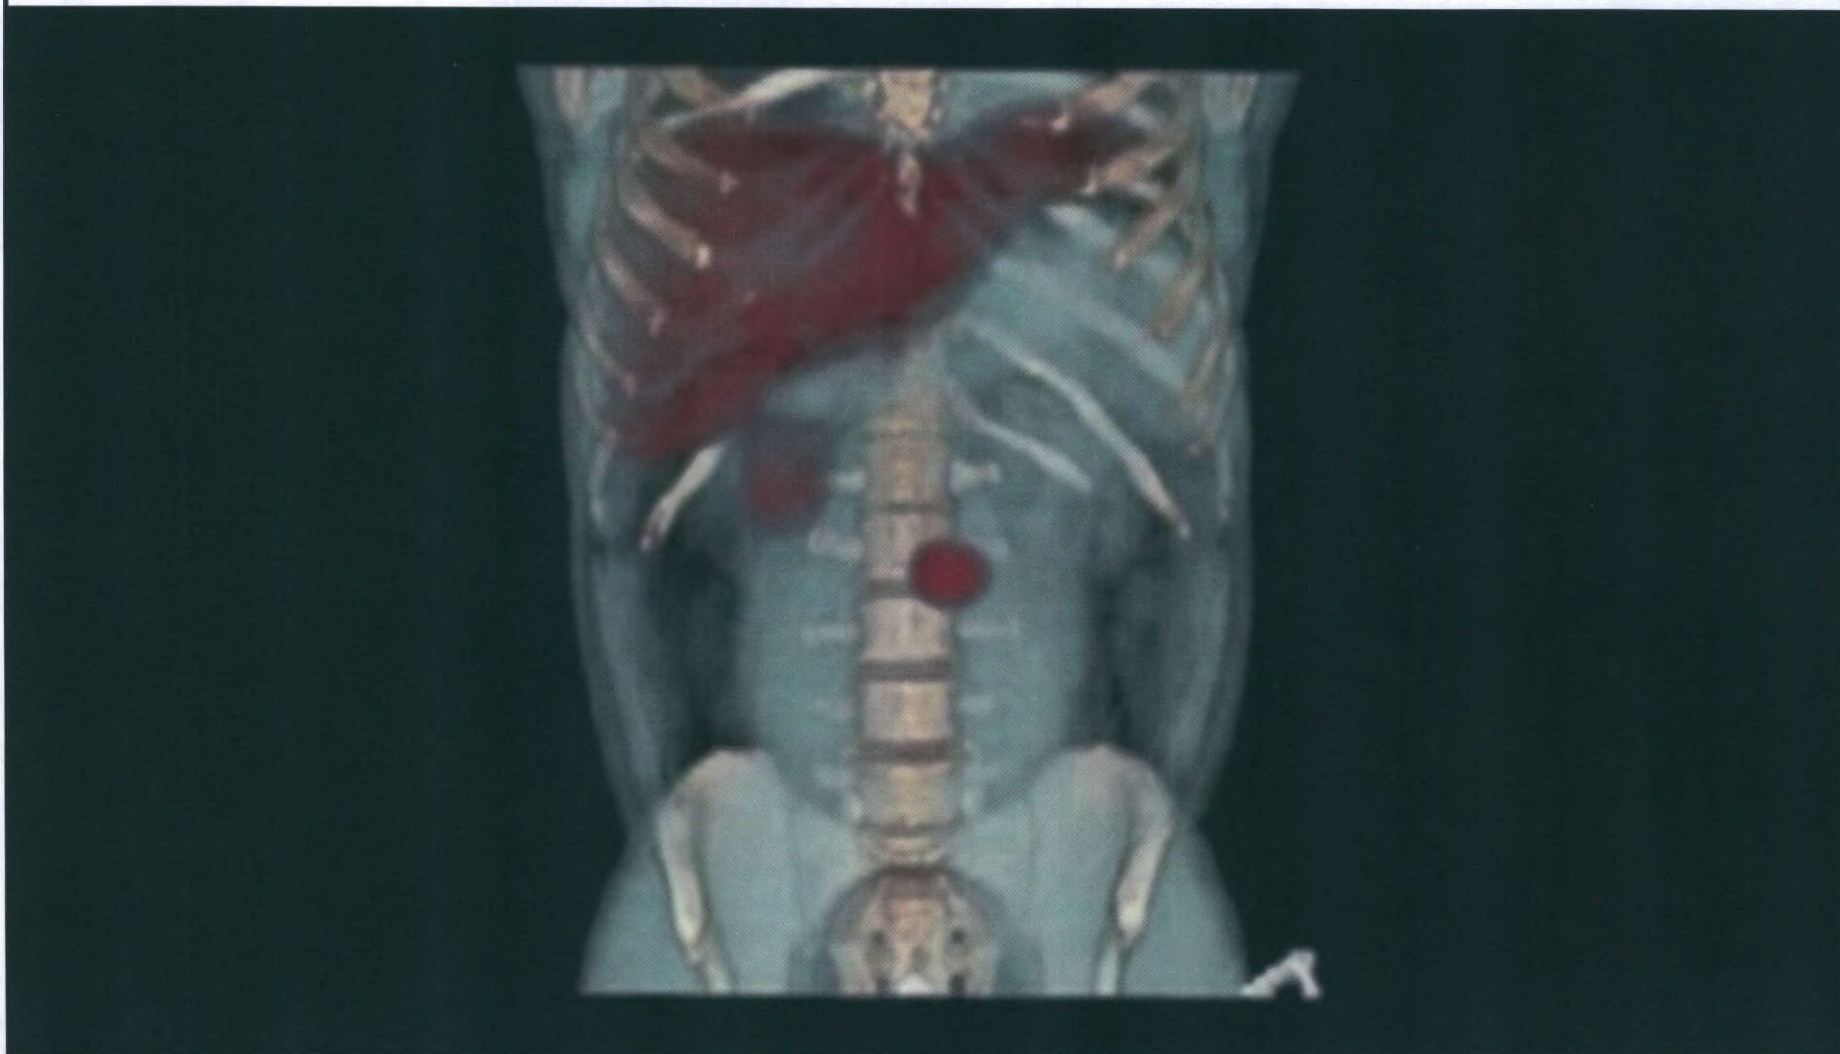

Программные пакеты для ОФЭКТ-исследований. (для вариантов исполнения Discovery NM 630 и NM 830)

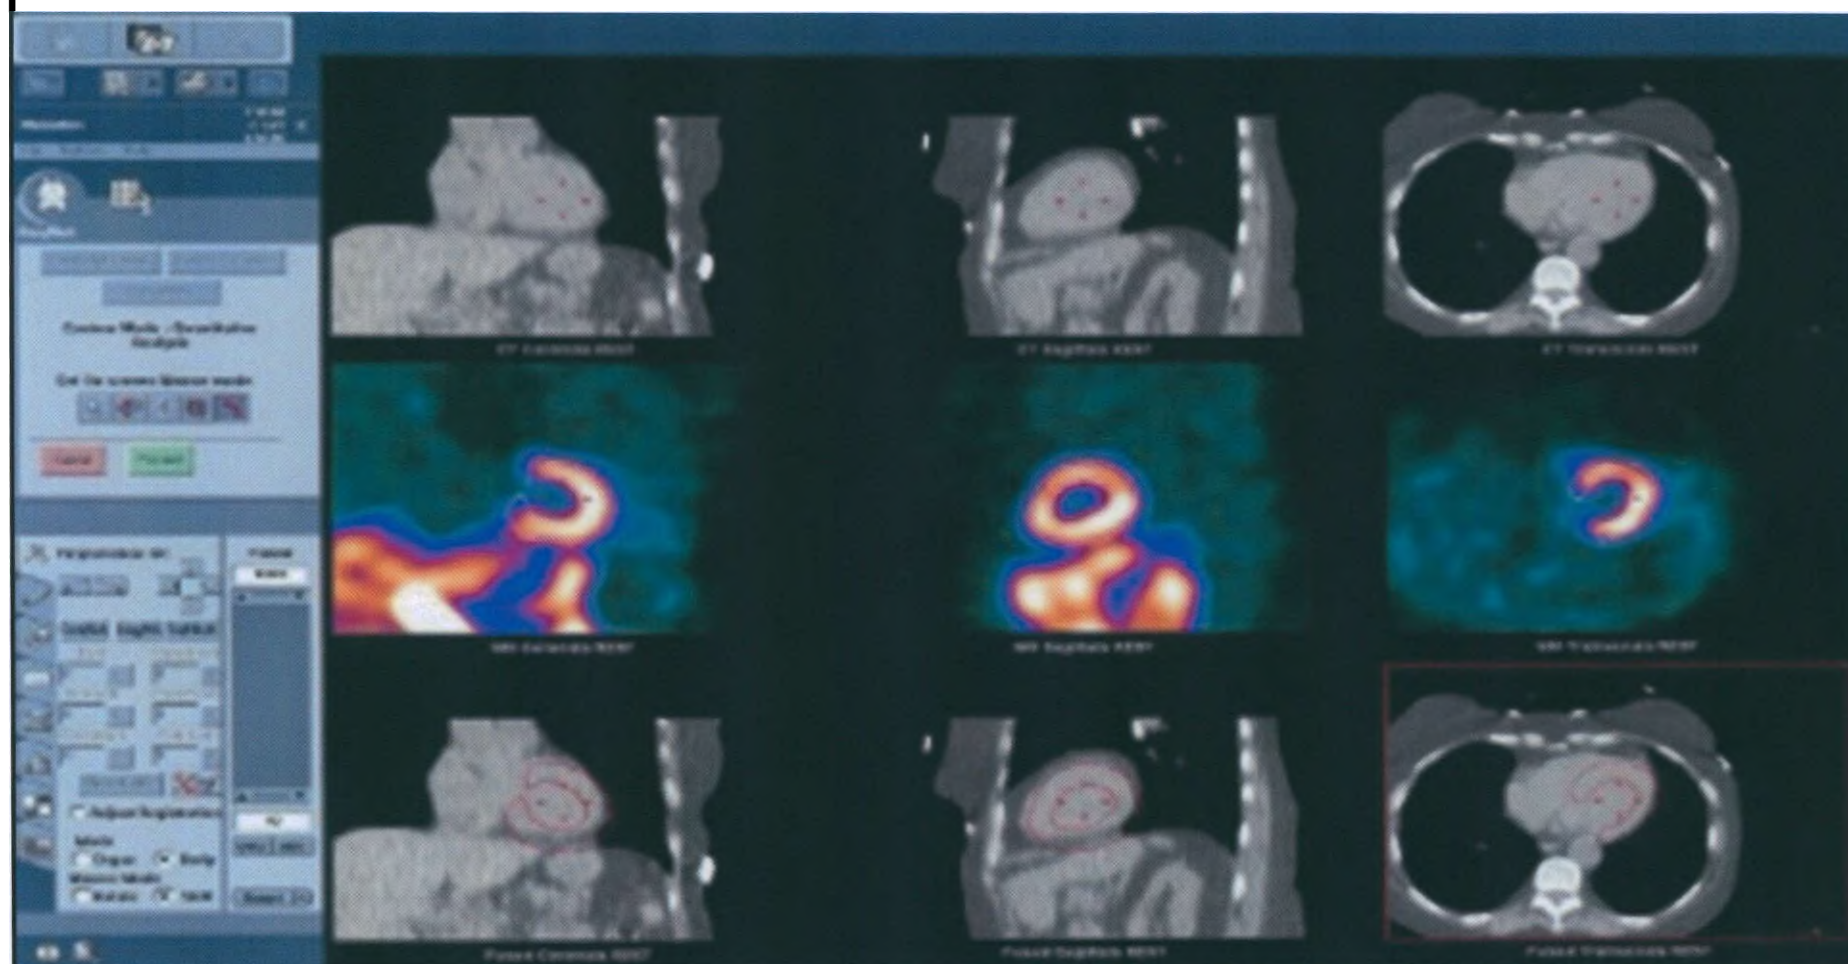


Программные пакеты для ОФЭКТ-исследований. (для вариантов исполнения **Discovery NM 630** и **NM 830**)

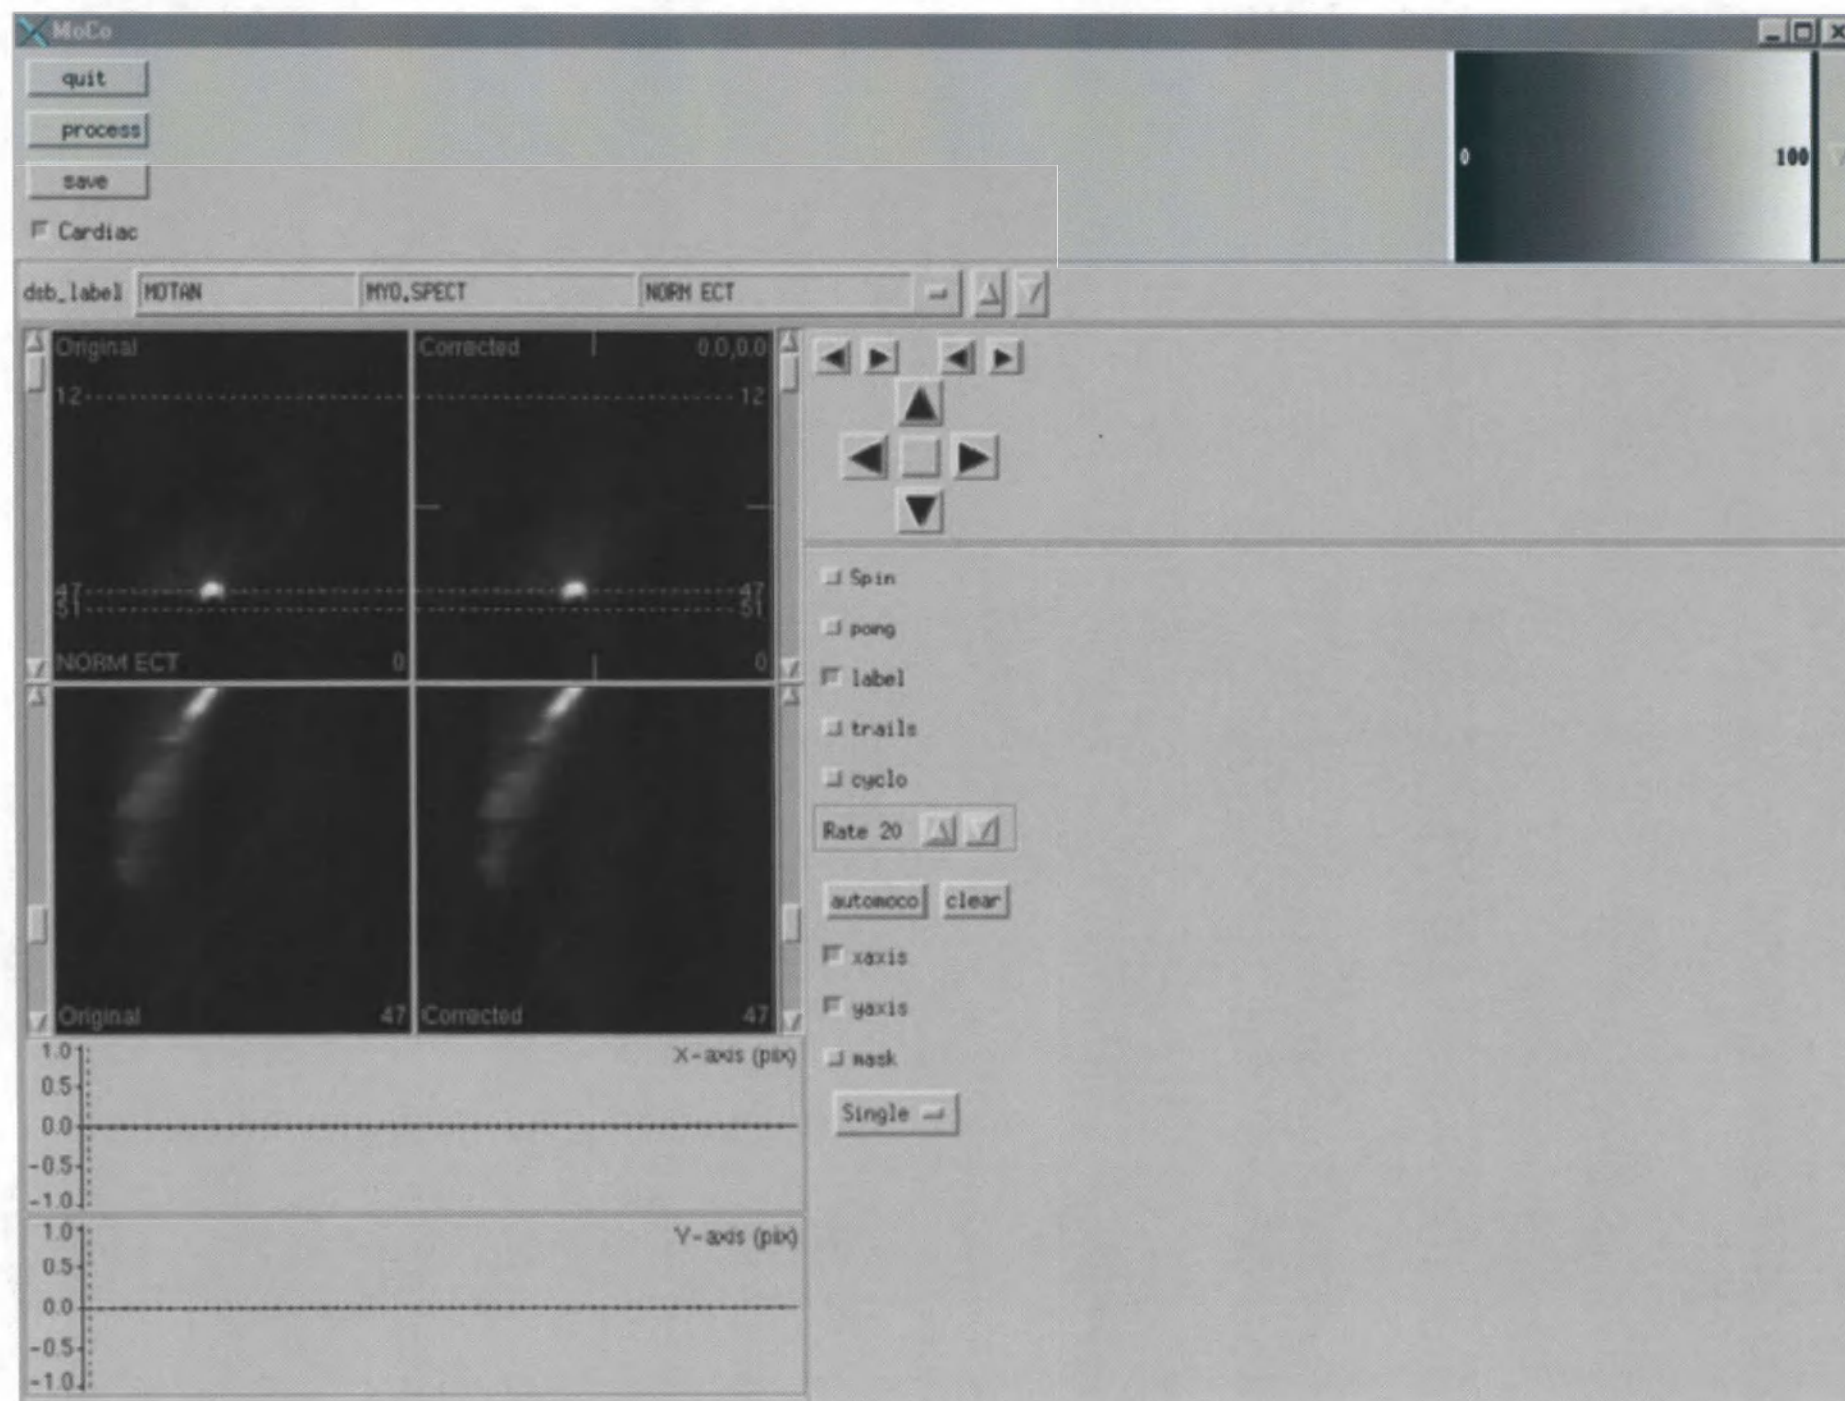



Emory Normal Database Generator

Normal File: test3 (separate Female)

ID: TheEmory1154
Name: broauID: EmoryCli371
Name: barpaID: TheEmory5949
Name: baxclID: EmoryCli395
Name: beama

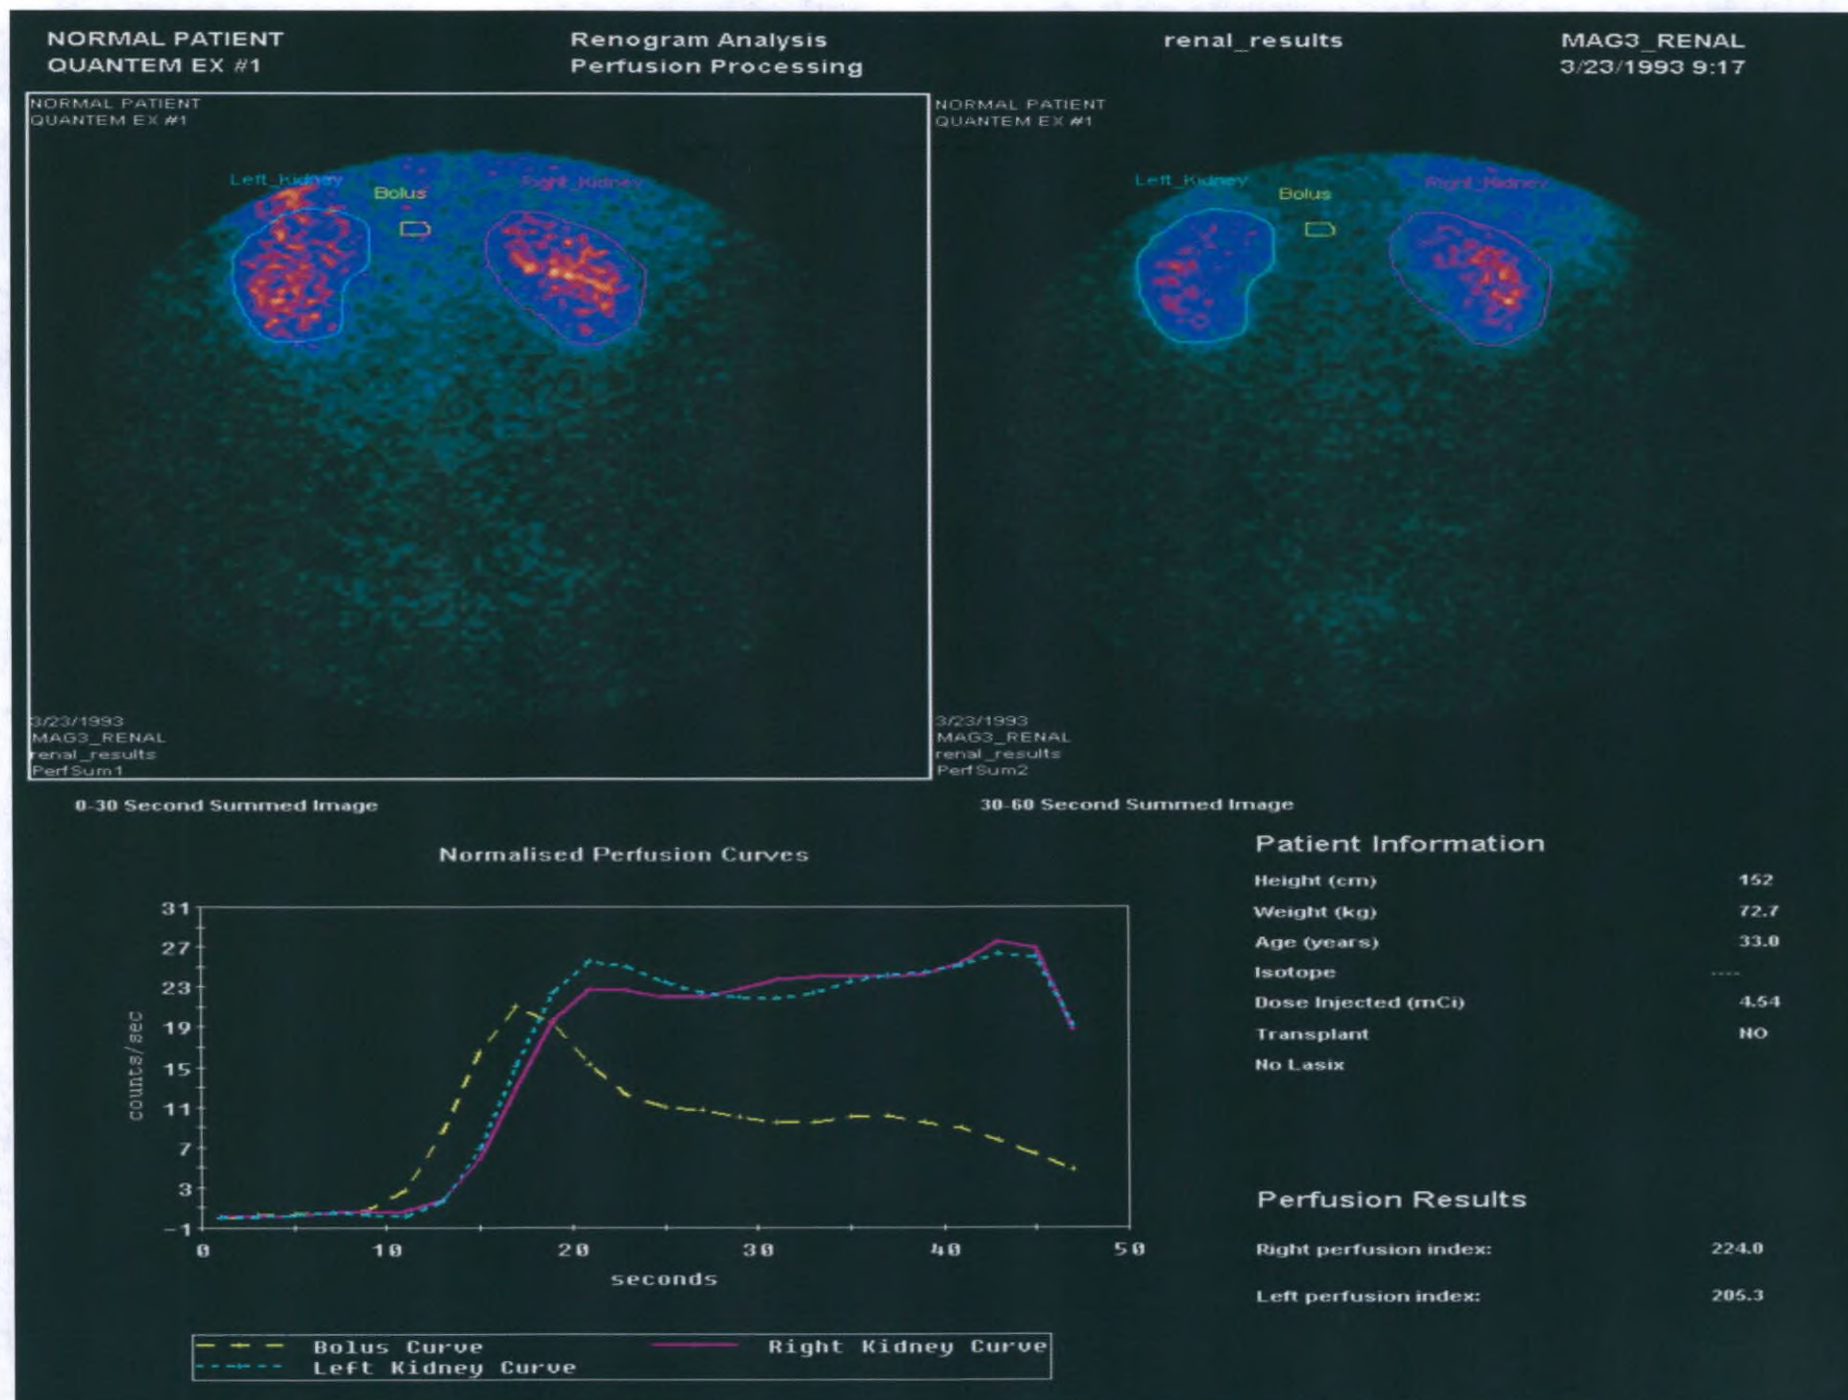

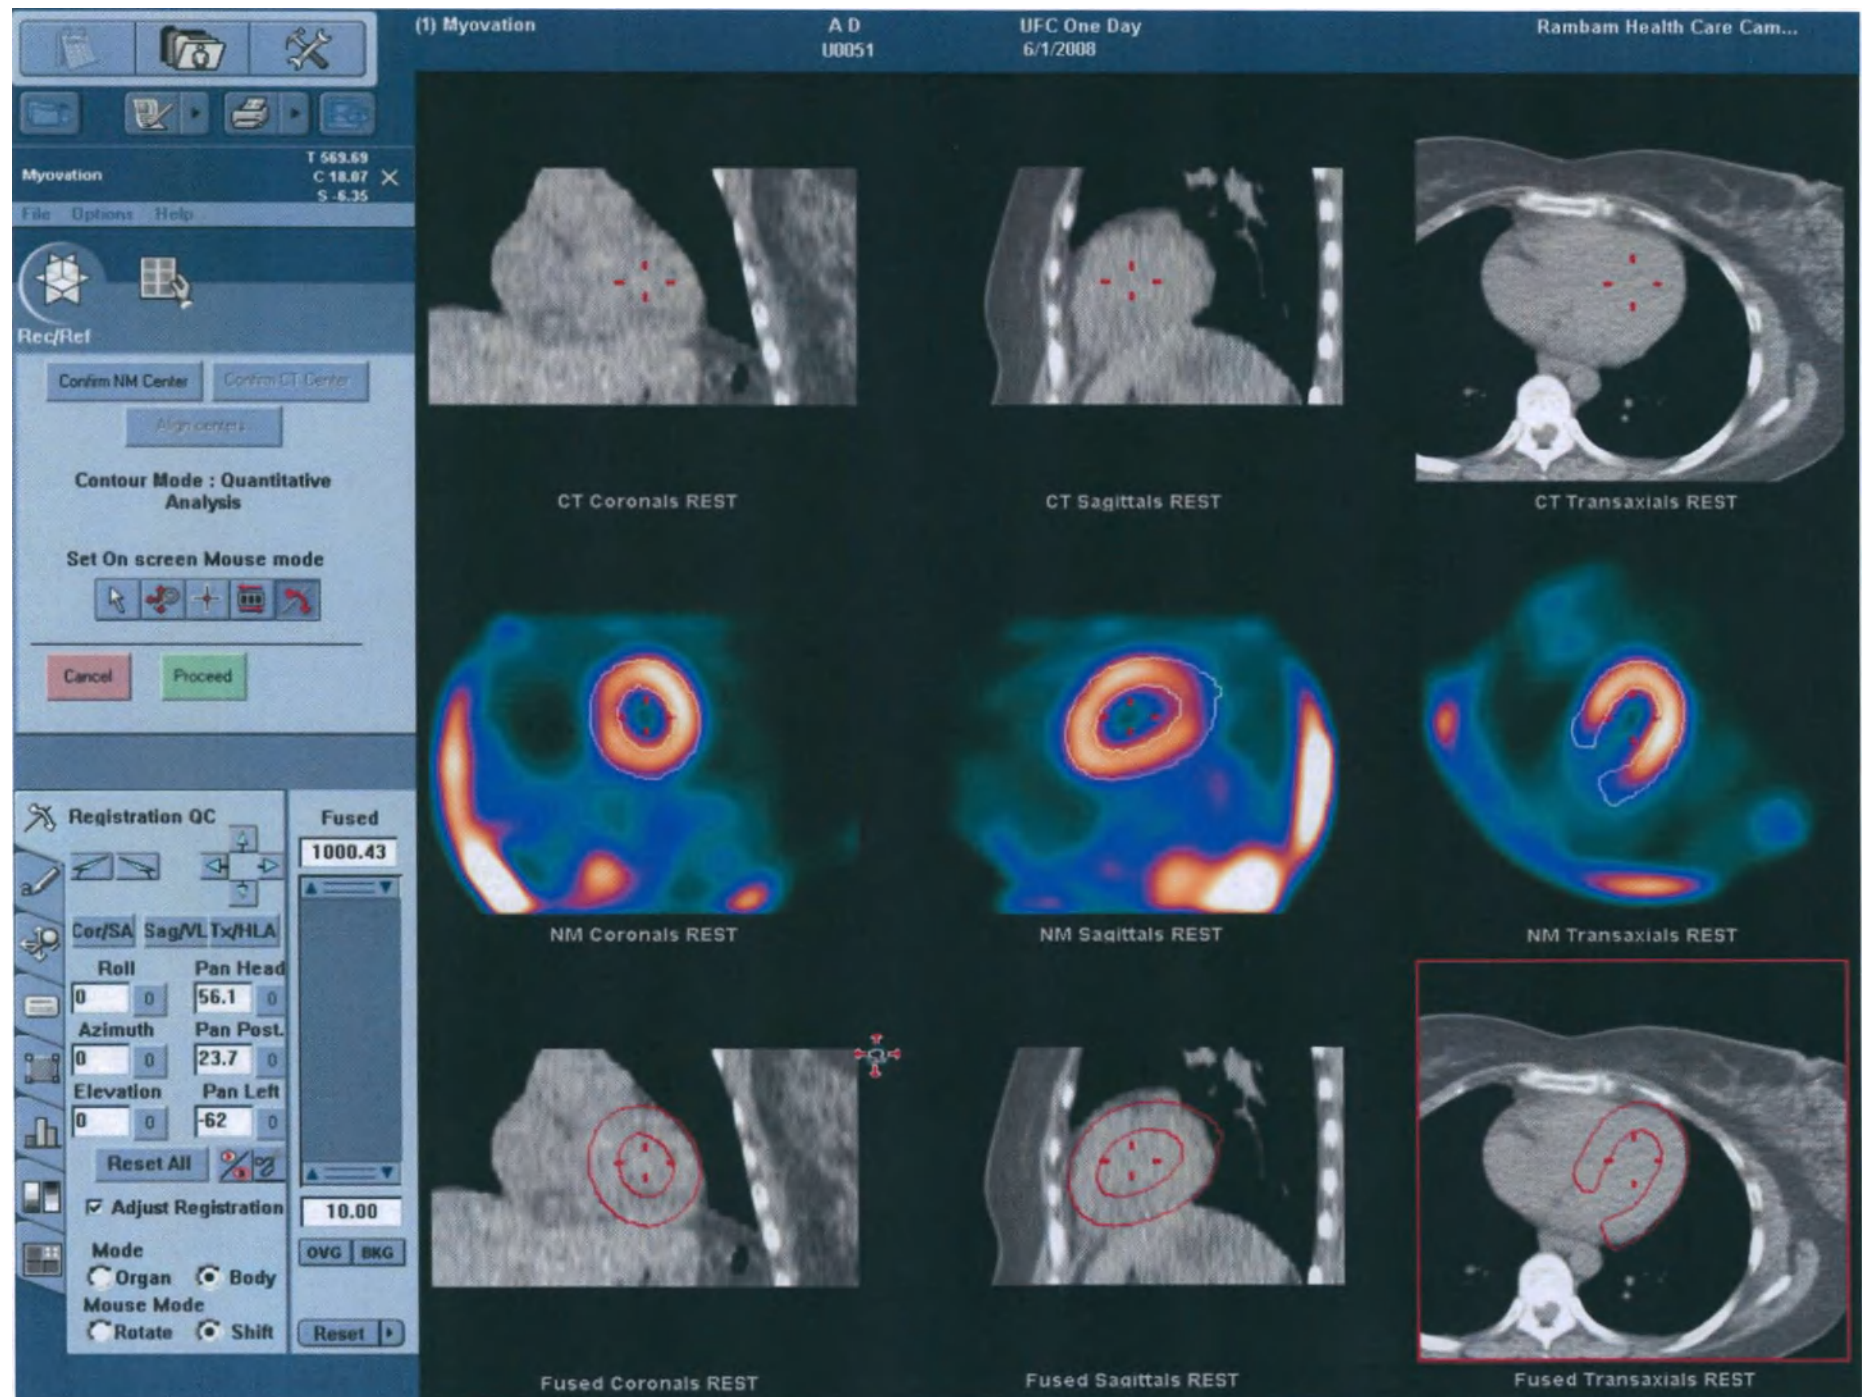

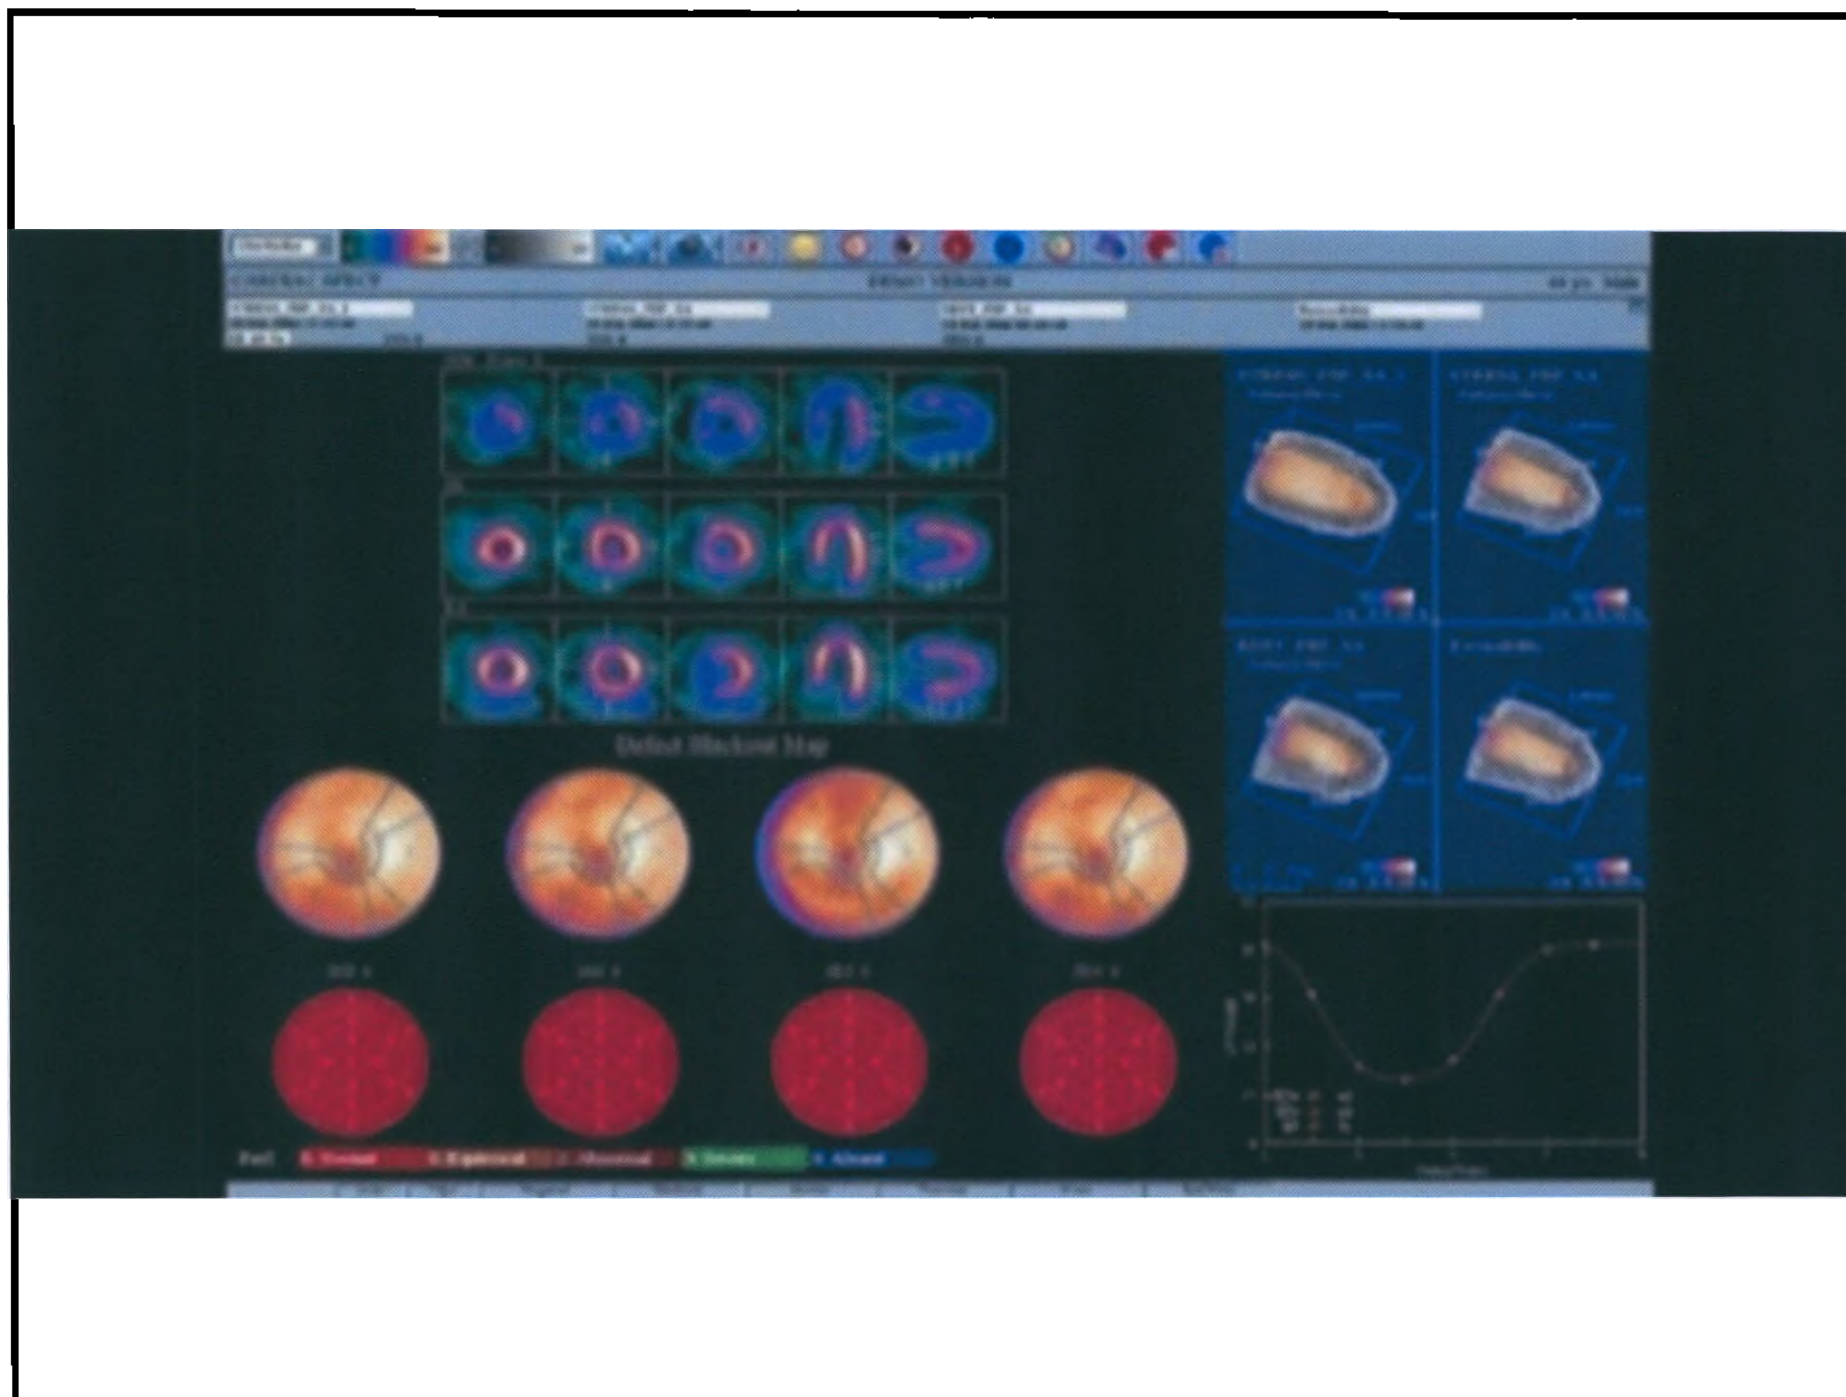

Process	Dual	Colorscale	Default	Normalize	
Sequence	Raw	Slice	Surface	Splash	Views
Results File	QGS Results			Prompt	

Raw	Slice	Surface	Splash	Views	Results	Snapshot	More
-----	-------	---------	--------	-------	---------	----------	------

Label	Contours	ED	ES	Blur	Smear	Spin	Gate	3D	Select	Gated	Active
-------	----------	----	----	------	-------	------	------	----	--------	-------	--------

Surface	Both	Function	Raw	Grid	None	View	RAO
---------	------	----------	-----	------	------	------	-----

Zoom 2	Scale 1.0	Rate 20
--------	-----------	---------


Snapshot File	QGS: Results
---------------	--------------


Stress Filter			Rest Filter		
Study			Study		
Dataset			Dataset		
Isotope	Tc		Isotope	Tl	

',' separates alternatives. '?' and '*' are wildcards. '^' matches beginning or end of line.

OK	Save	Reload	Reset	Cancel
----	------	--------	-------	--------



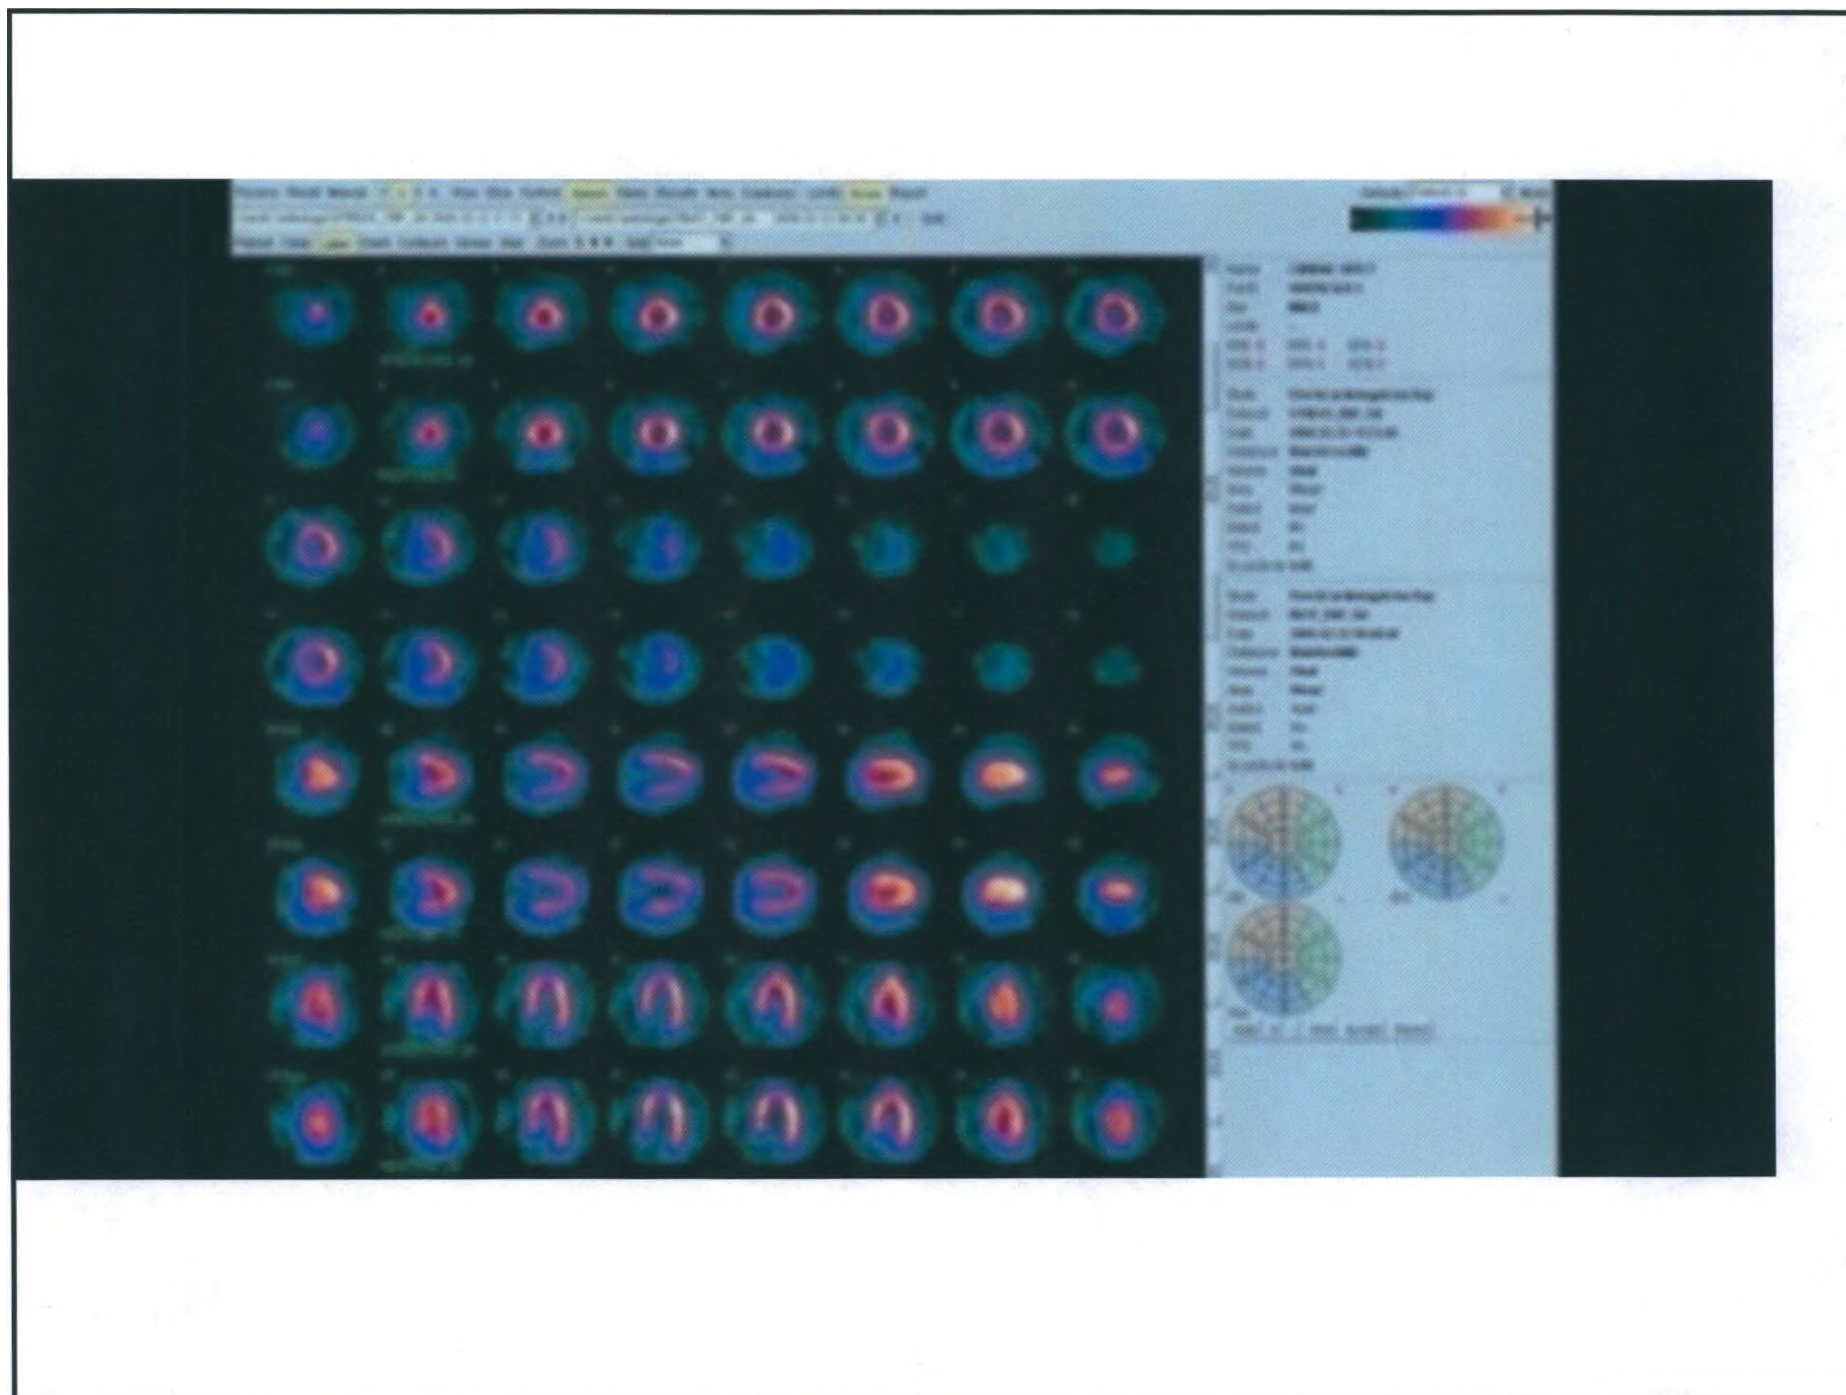

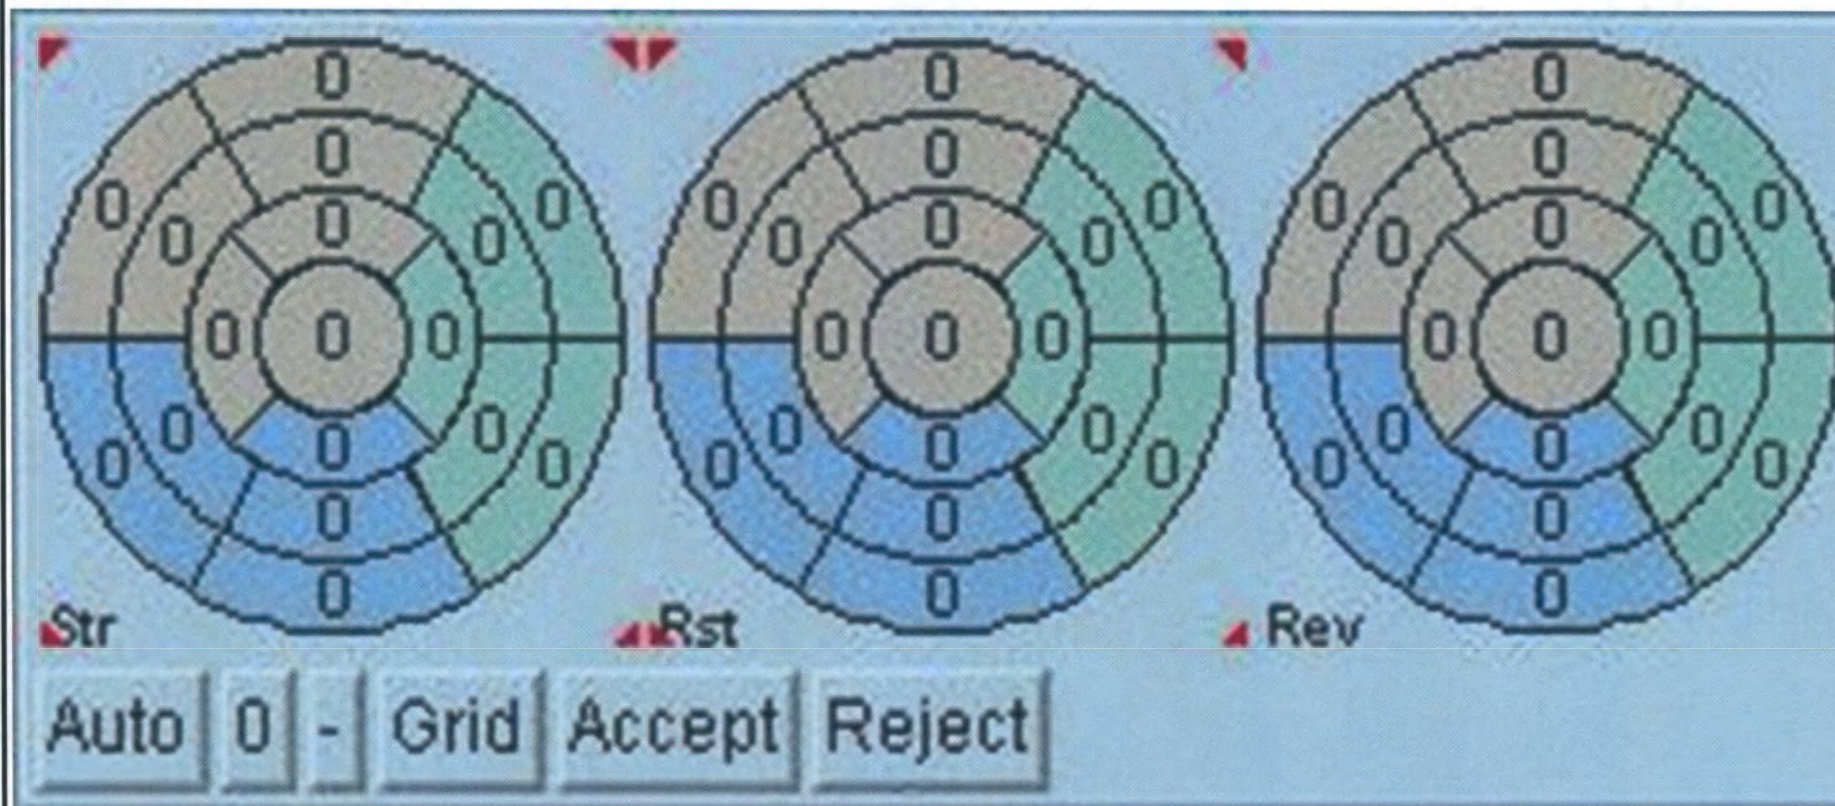

	S	R		S	R		S	R		S	R
1. Anterior	0	0	7. Anterior	0	0	1. Anterior	0	0			
2. Apical	0	0	8. Anteroseptal	0	0	2. Anteroseptal	0	0			
3. Inferior	0	0	9. Inferoseptal	0	0	3. Inferoseptal	0	0			
4. Lateral	0	0	10. Inferolateral	0	0	4. Inferolateral	0	0			
			11. Basolateral	0	0	5. Basolateral	0	0			

SAAS = 12 (normal)

SAAS = 9 (normal)

SAAS = 9 (normal)

As seen on the left, the patient has a normal left ventricle with a normal ejection fraction (EF) of 55% (normal EF is 55-70%). The right ventricle is normal in size and function. The left ventricle is normal in size and function. The right ventricle is normal in size and function.

Findings:

Normal left ventricle.

View	Findings
Anterior	Normal left ventricle (normal EF)
Lateral	Normal left ventricle (normal EF)
Inferior	Normal left ventricle (normal EF)


The left ventricle is normal in size and function. The right ventricle is normal in size and function. The left ventricle is normal in size and function. The right ventricle is normal in size and function.


Signature: [Signature]


Signature: [Signature]


SAAS (Normal)	SAAS (Normal)	SAAS (Normal)	SAAS (Normal)
Normal	8-10%	Normal	8-10%
Mild	11-15%	Mild	11-15%
Moderate	16-20%	Moderate	16-20%
Severe	>21%	Severe	>21%


Code Name	Change
1. Patient	001
2. Age	65
3. Sex	Male
4. Date	12/12/2005
5. Time	12:00
6. Height	170 cm
7. Weight	70 kg
8. Heart Rate	60 bpm
9. Blood Pressure	120/80 mmHg
10. Oxygen Saturation	98%
11. ECG	Normal
12. Notes	Normal left ventricle.

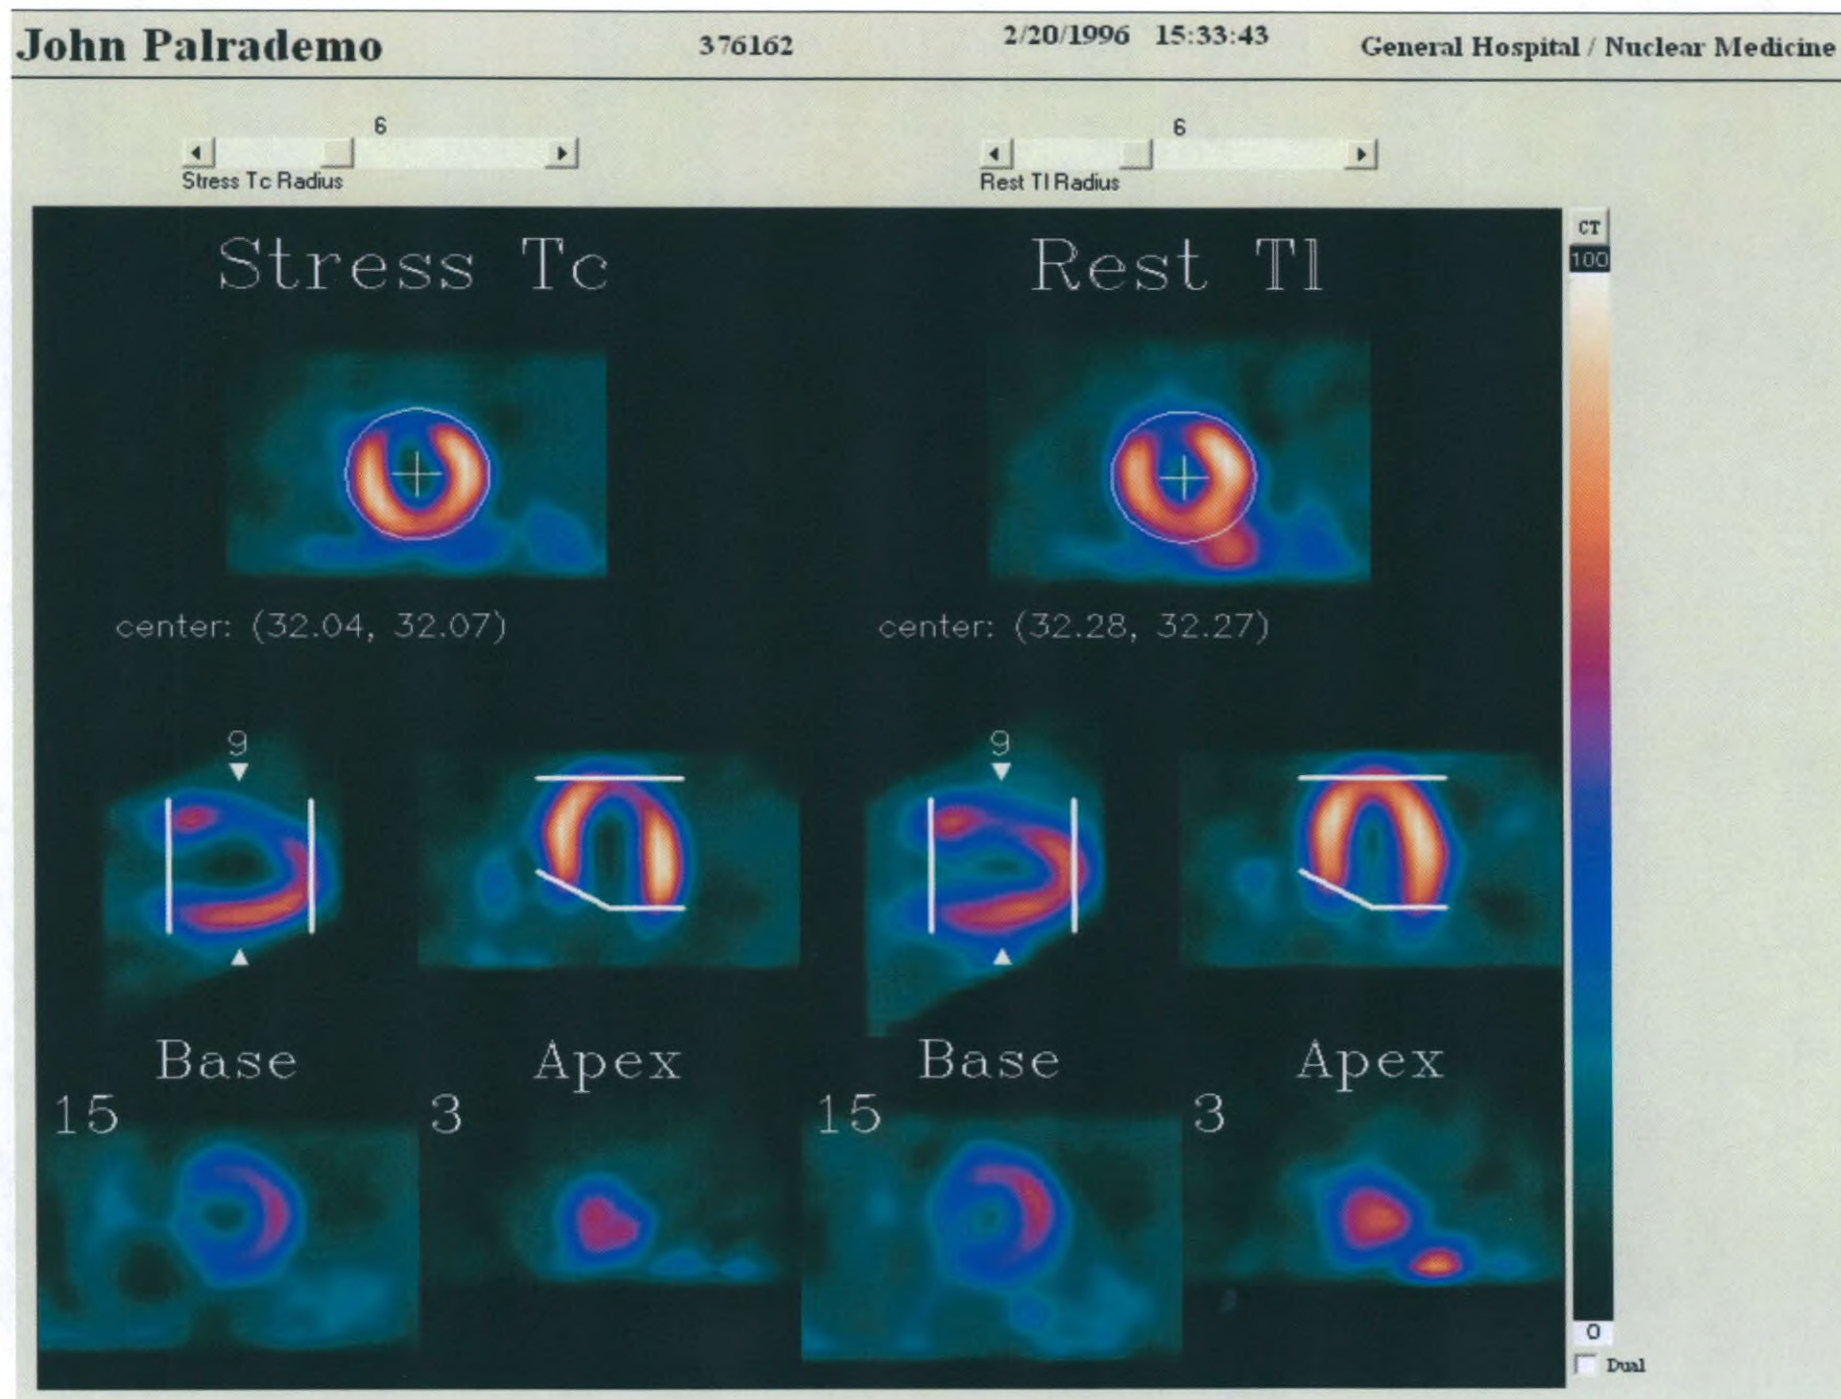


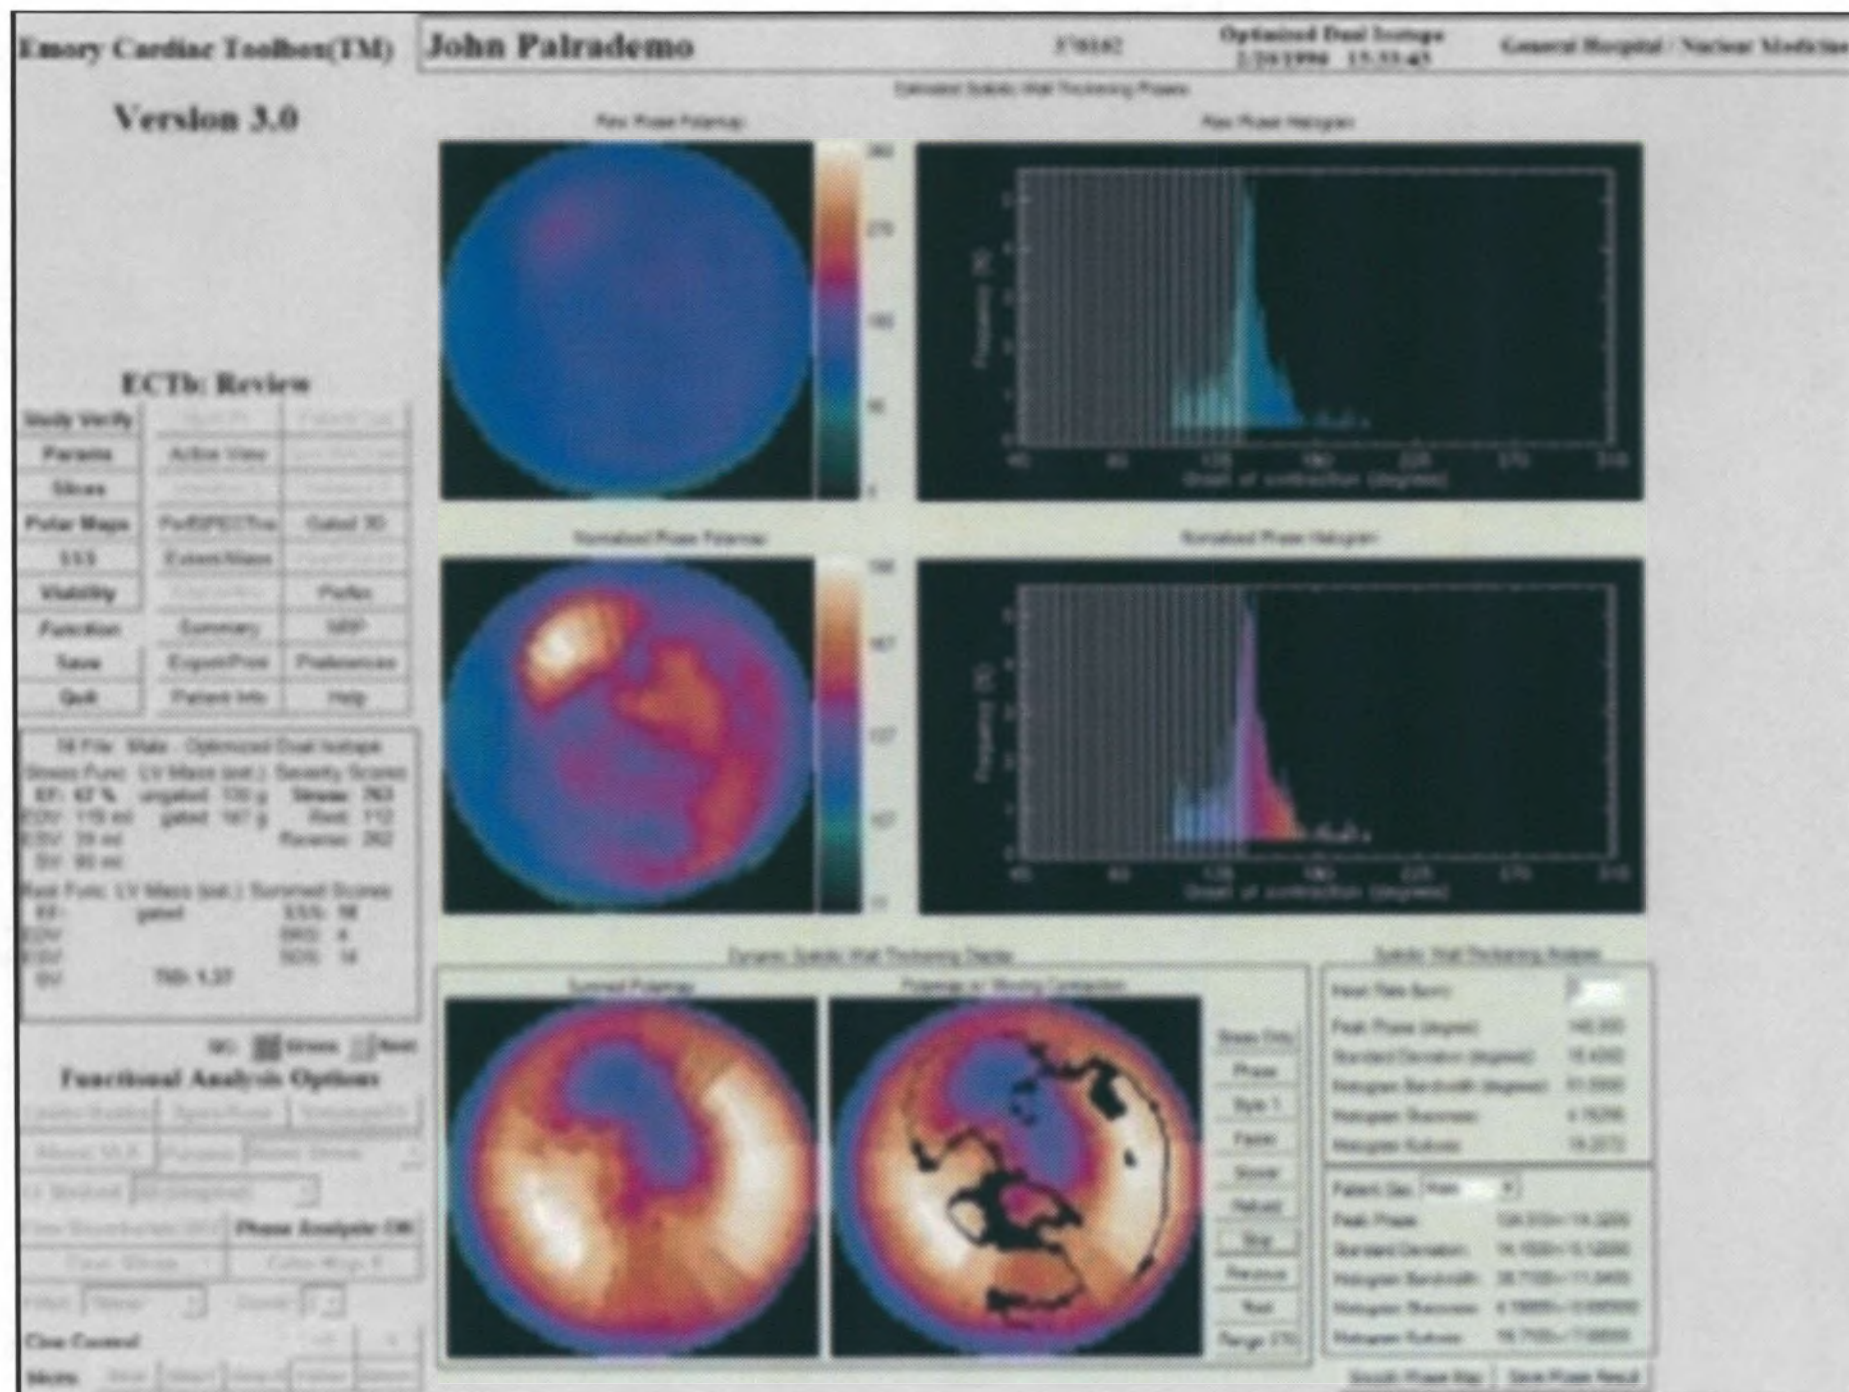


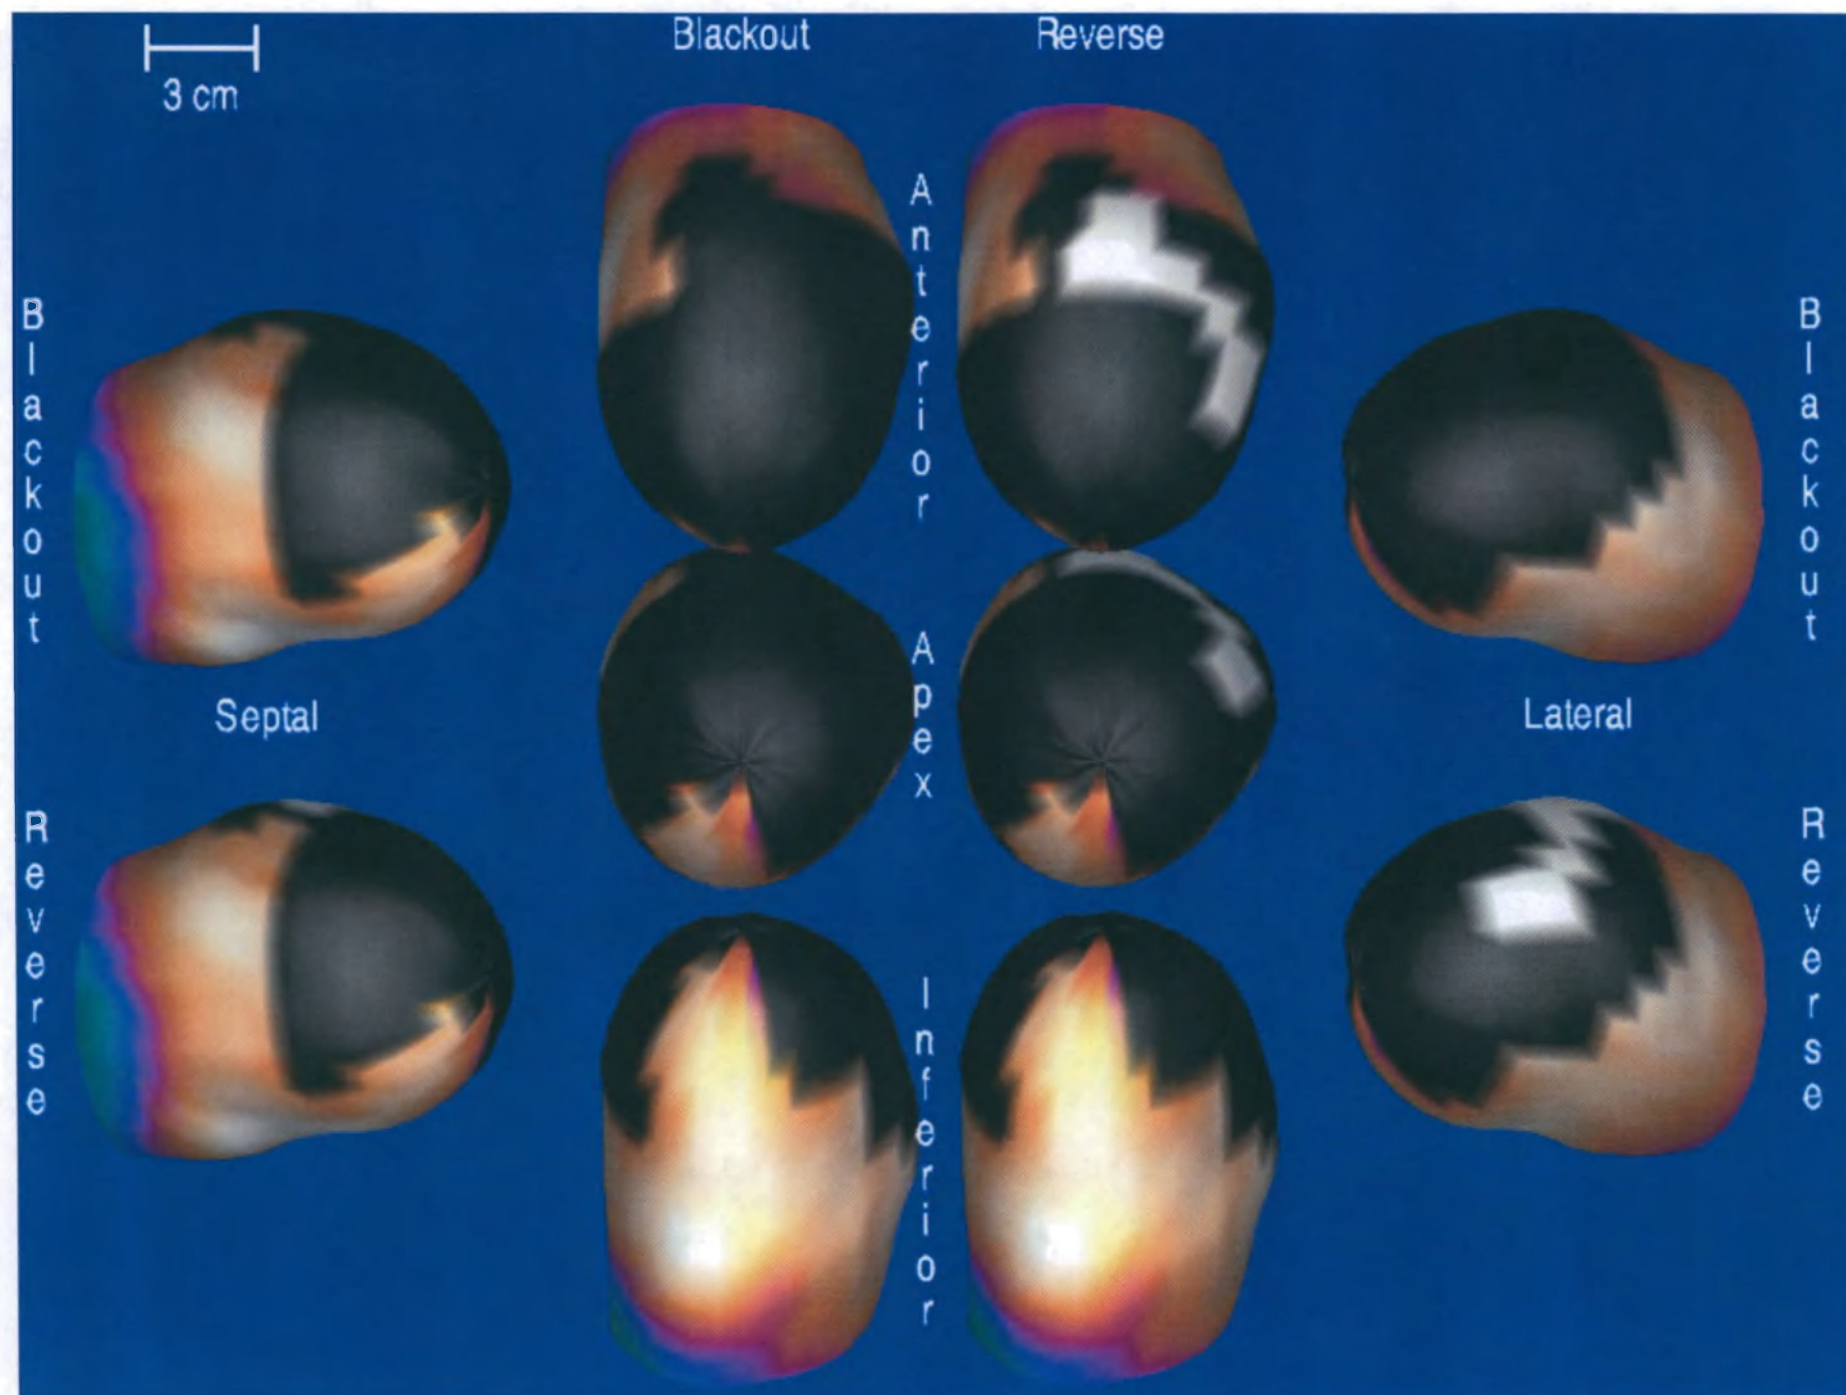


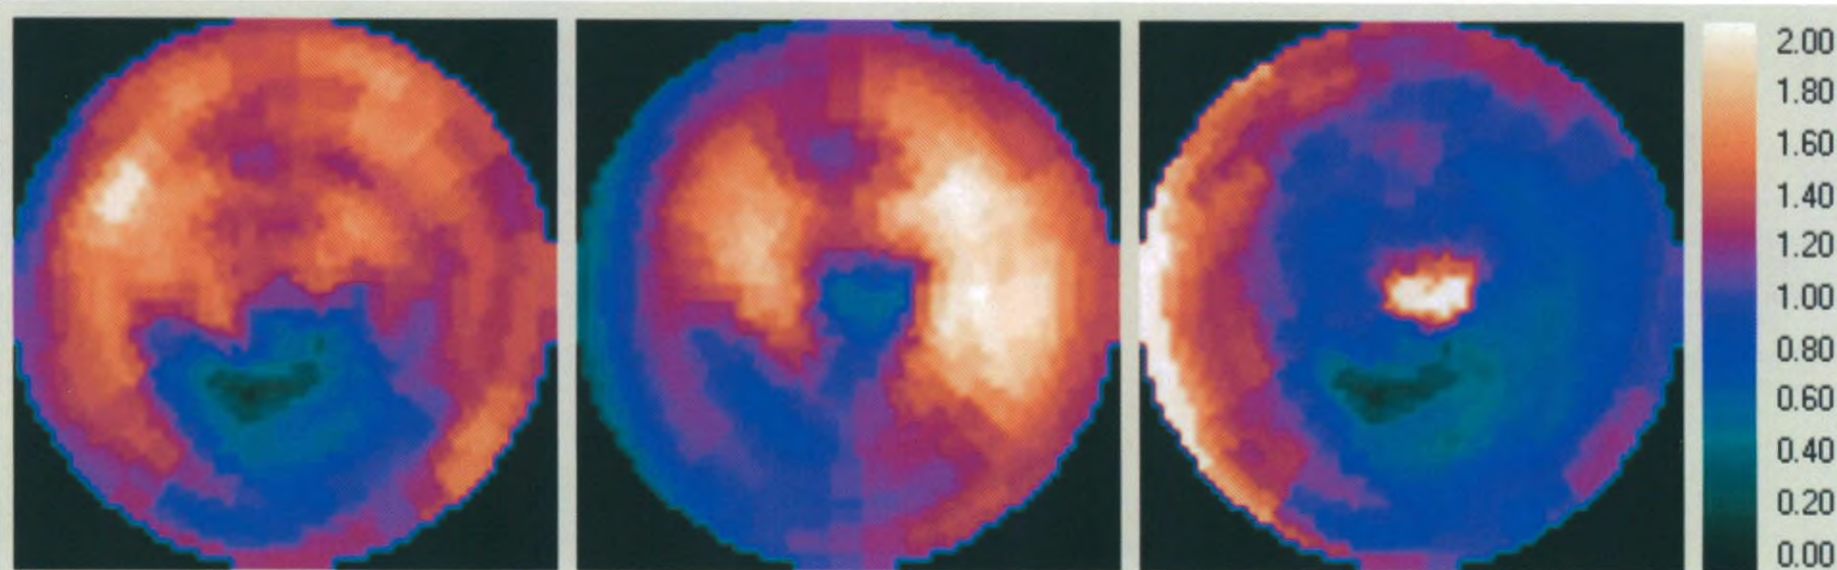


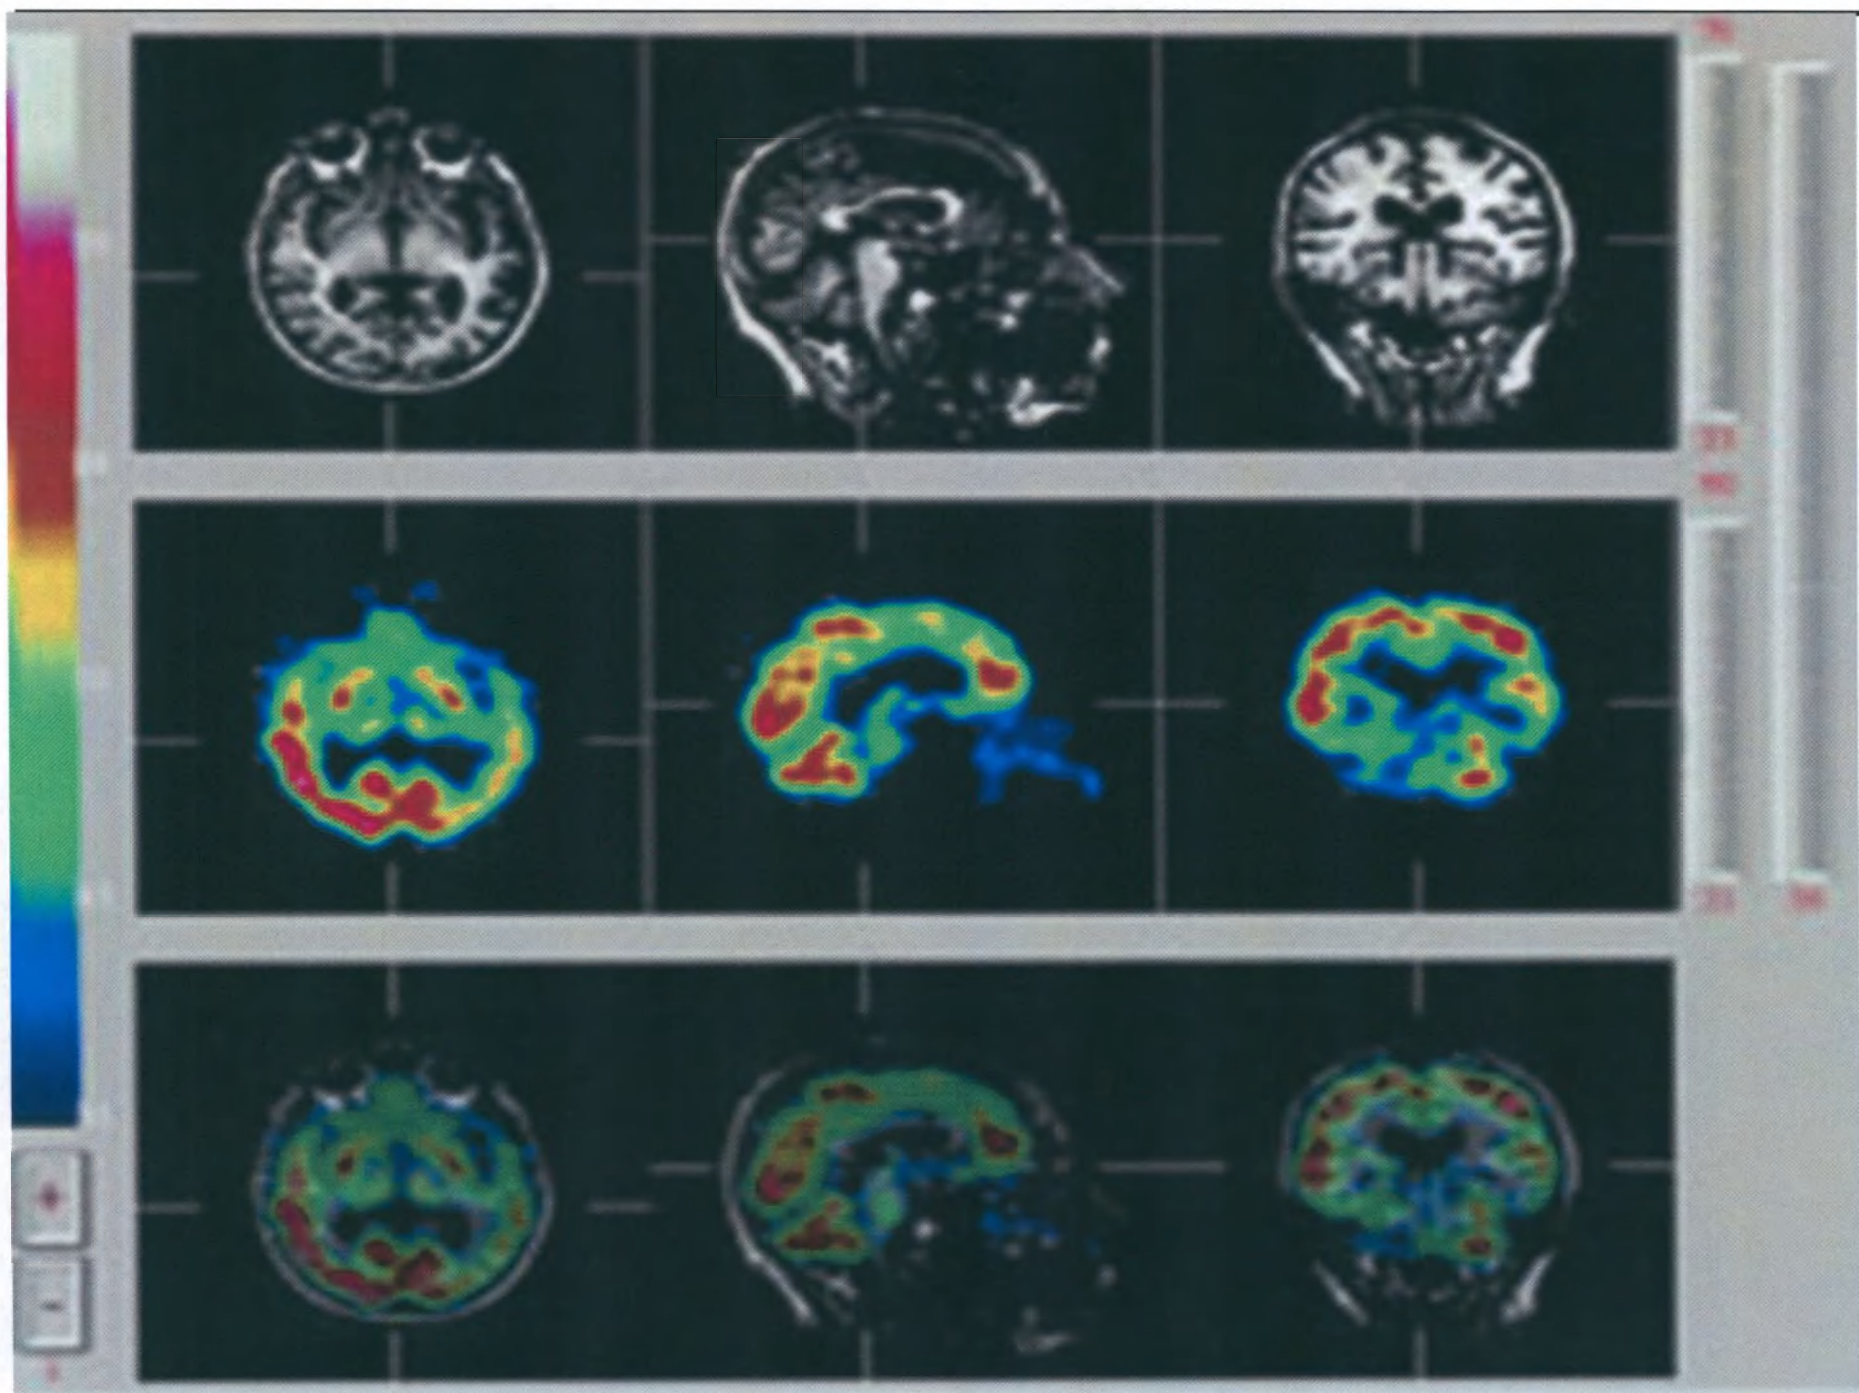


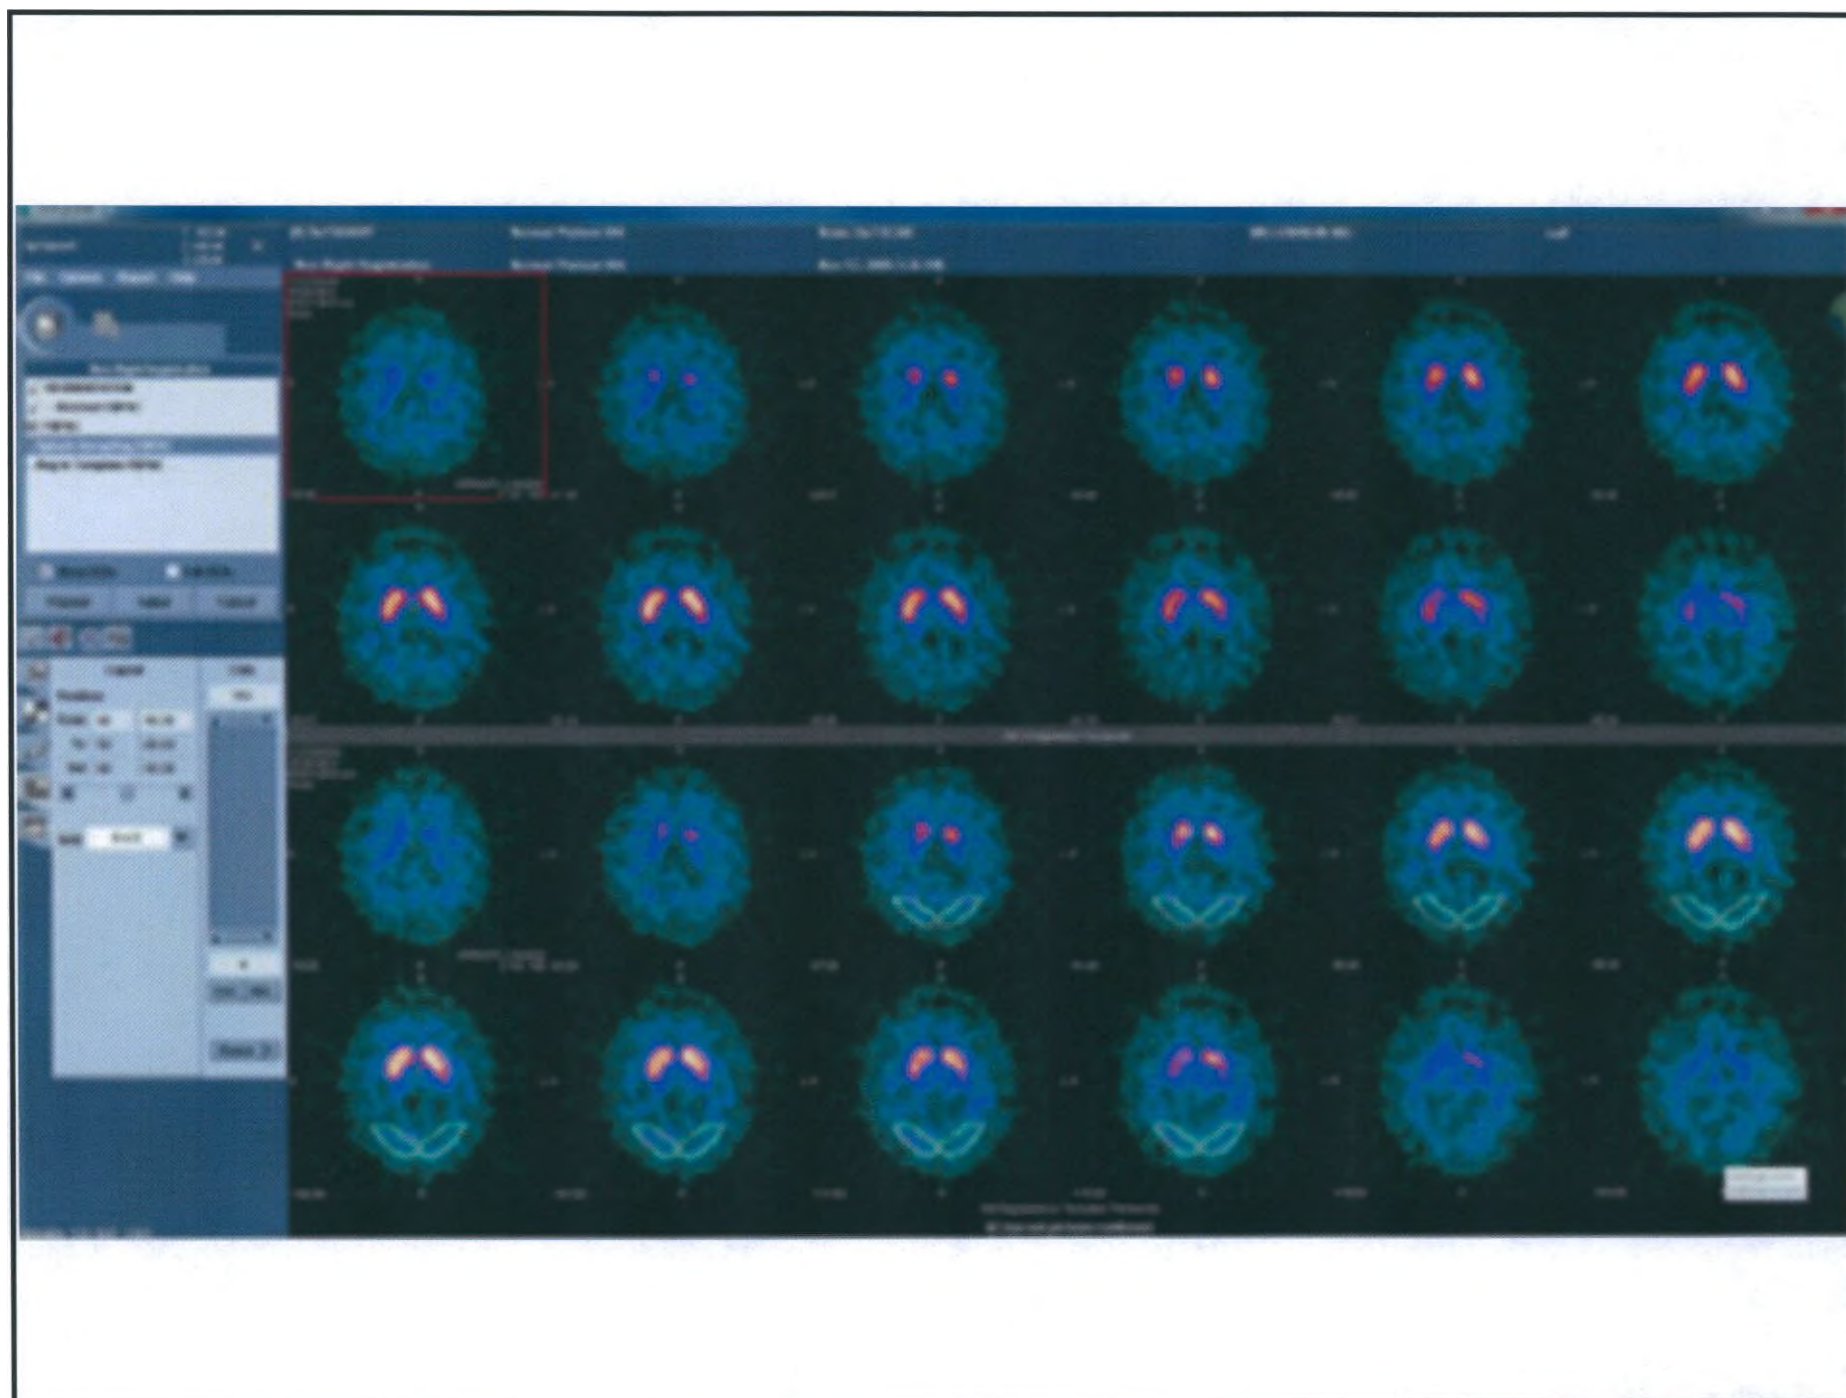

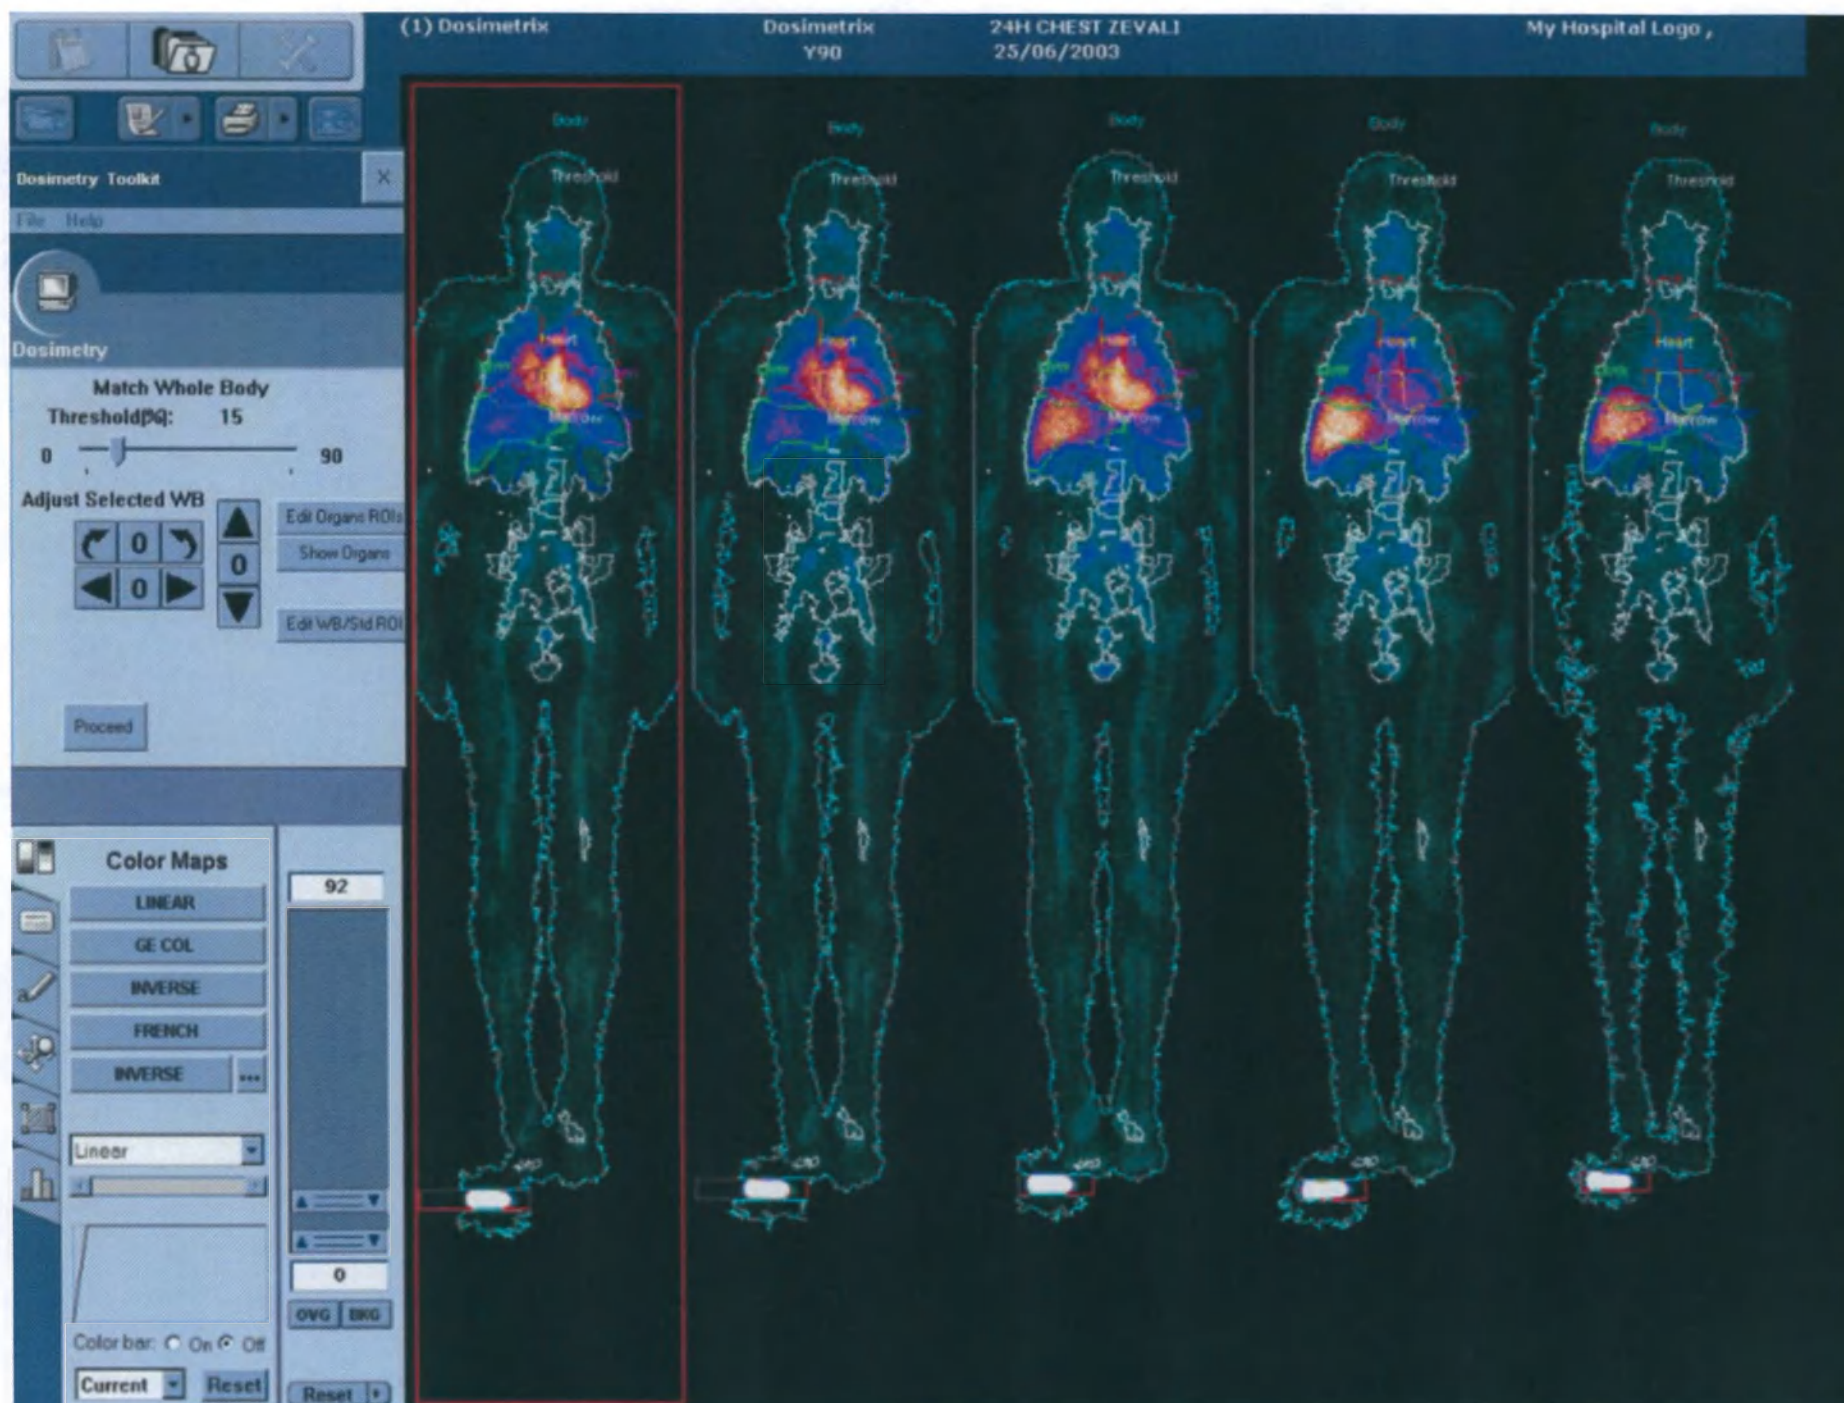

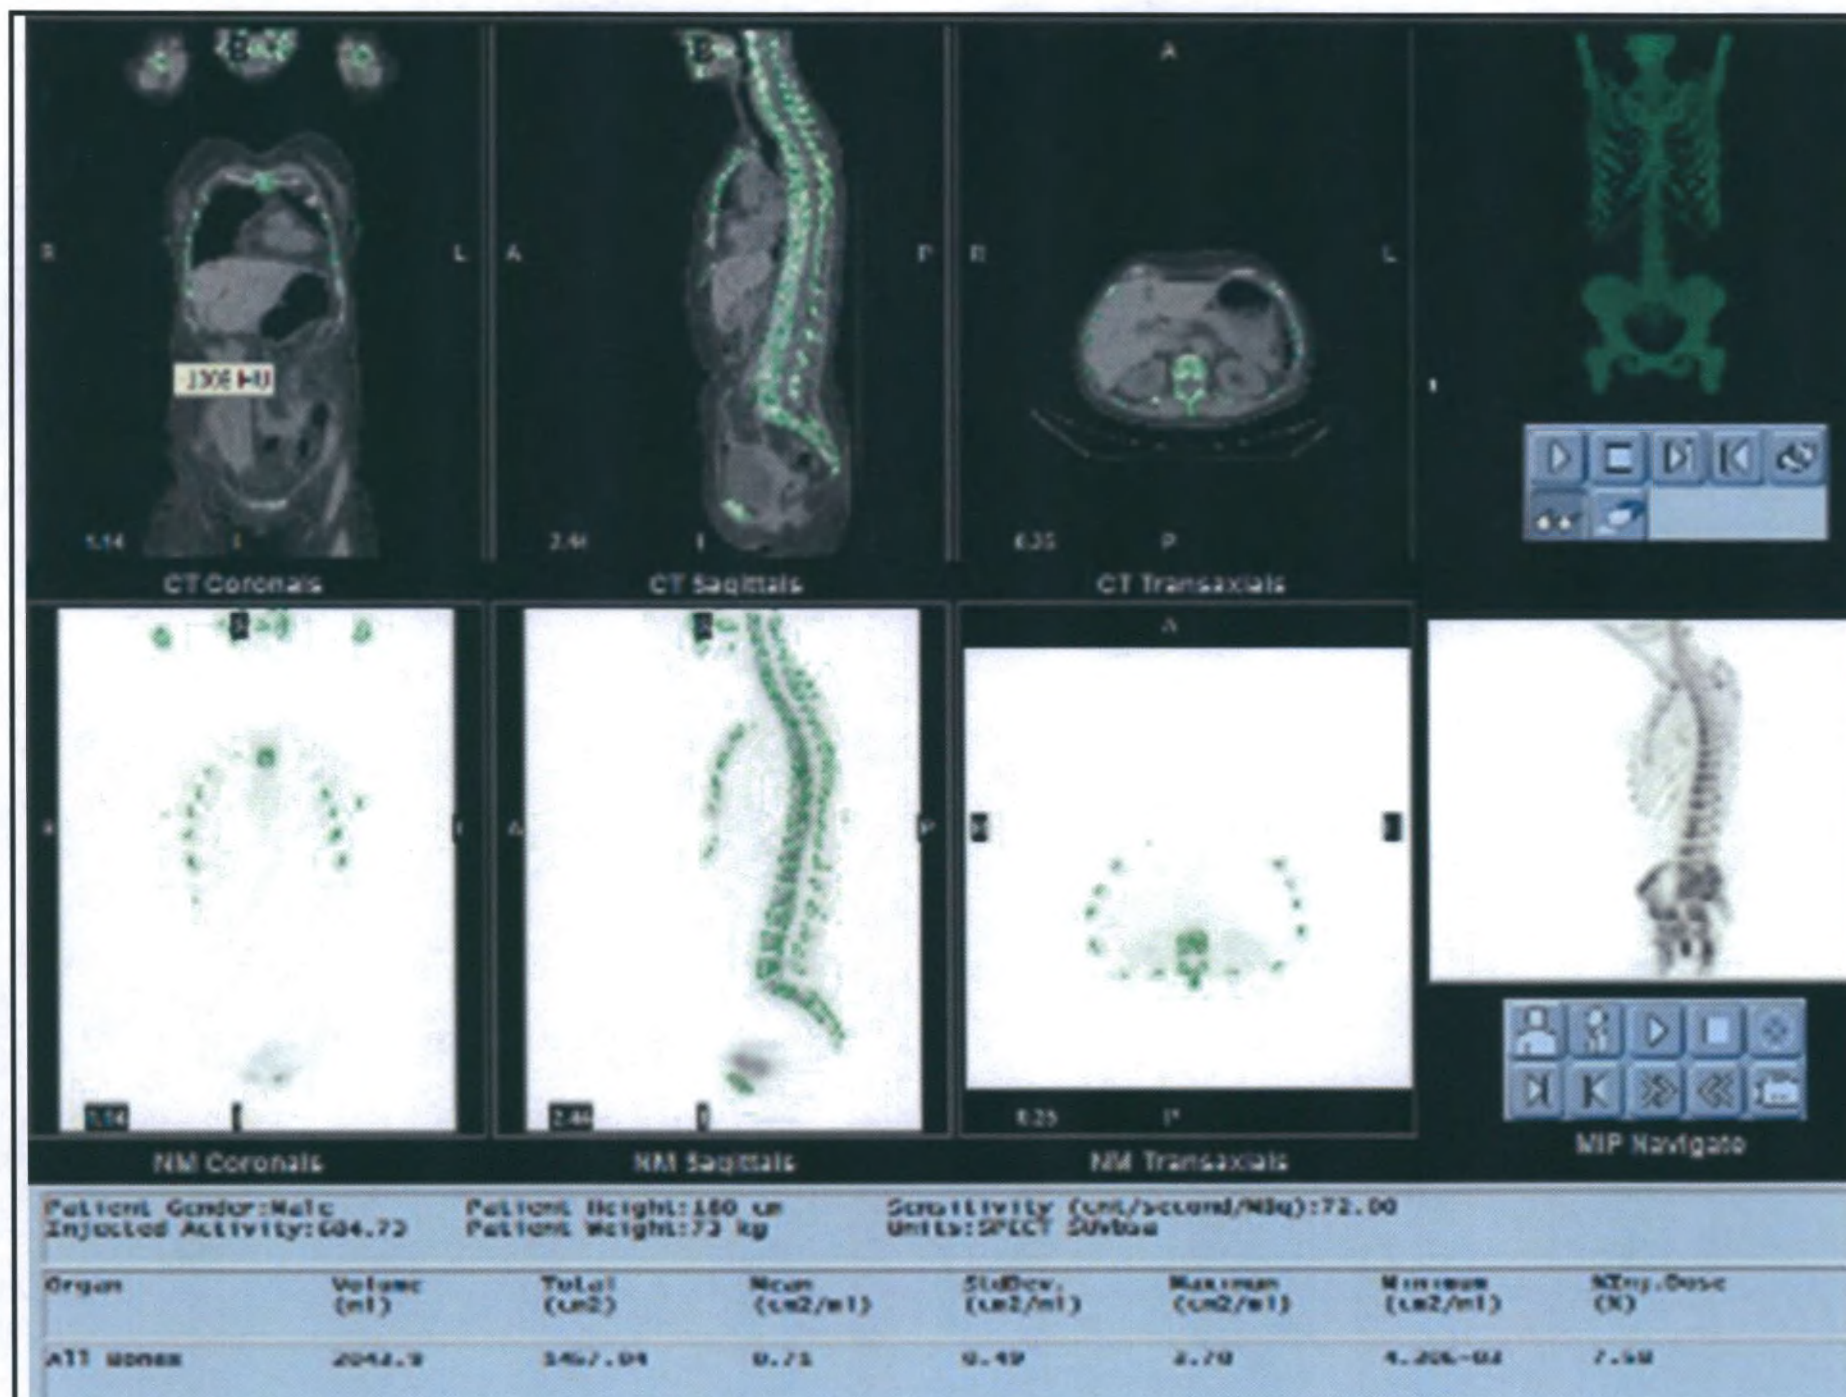

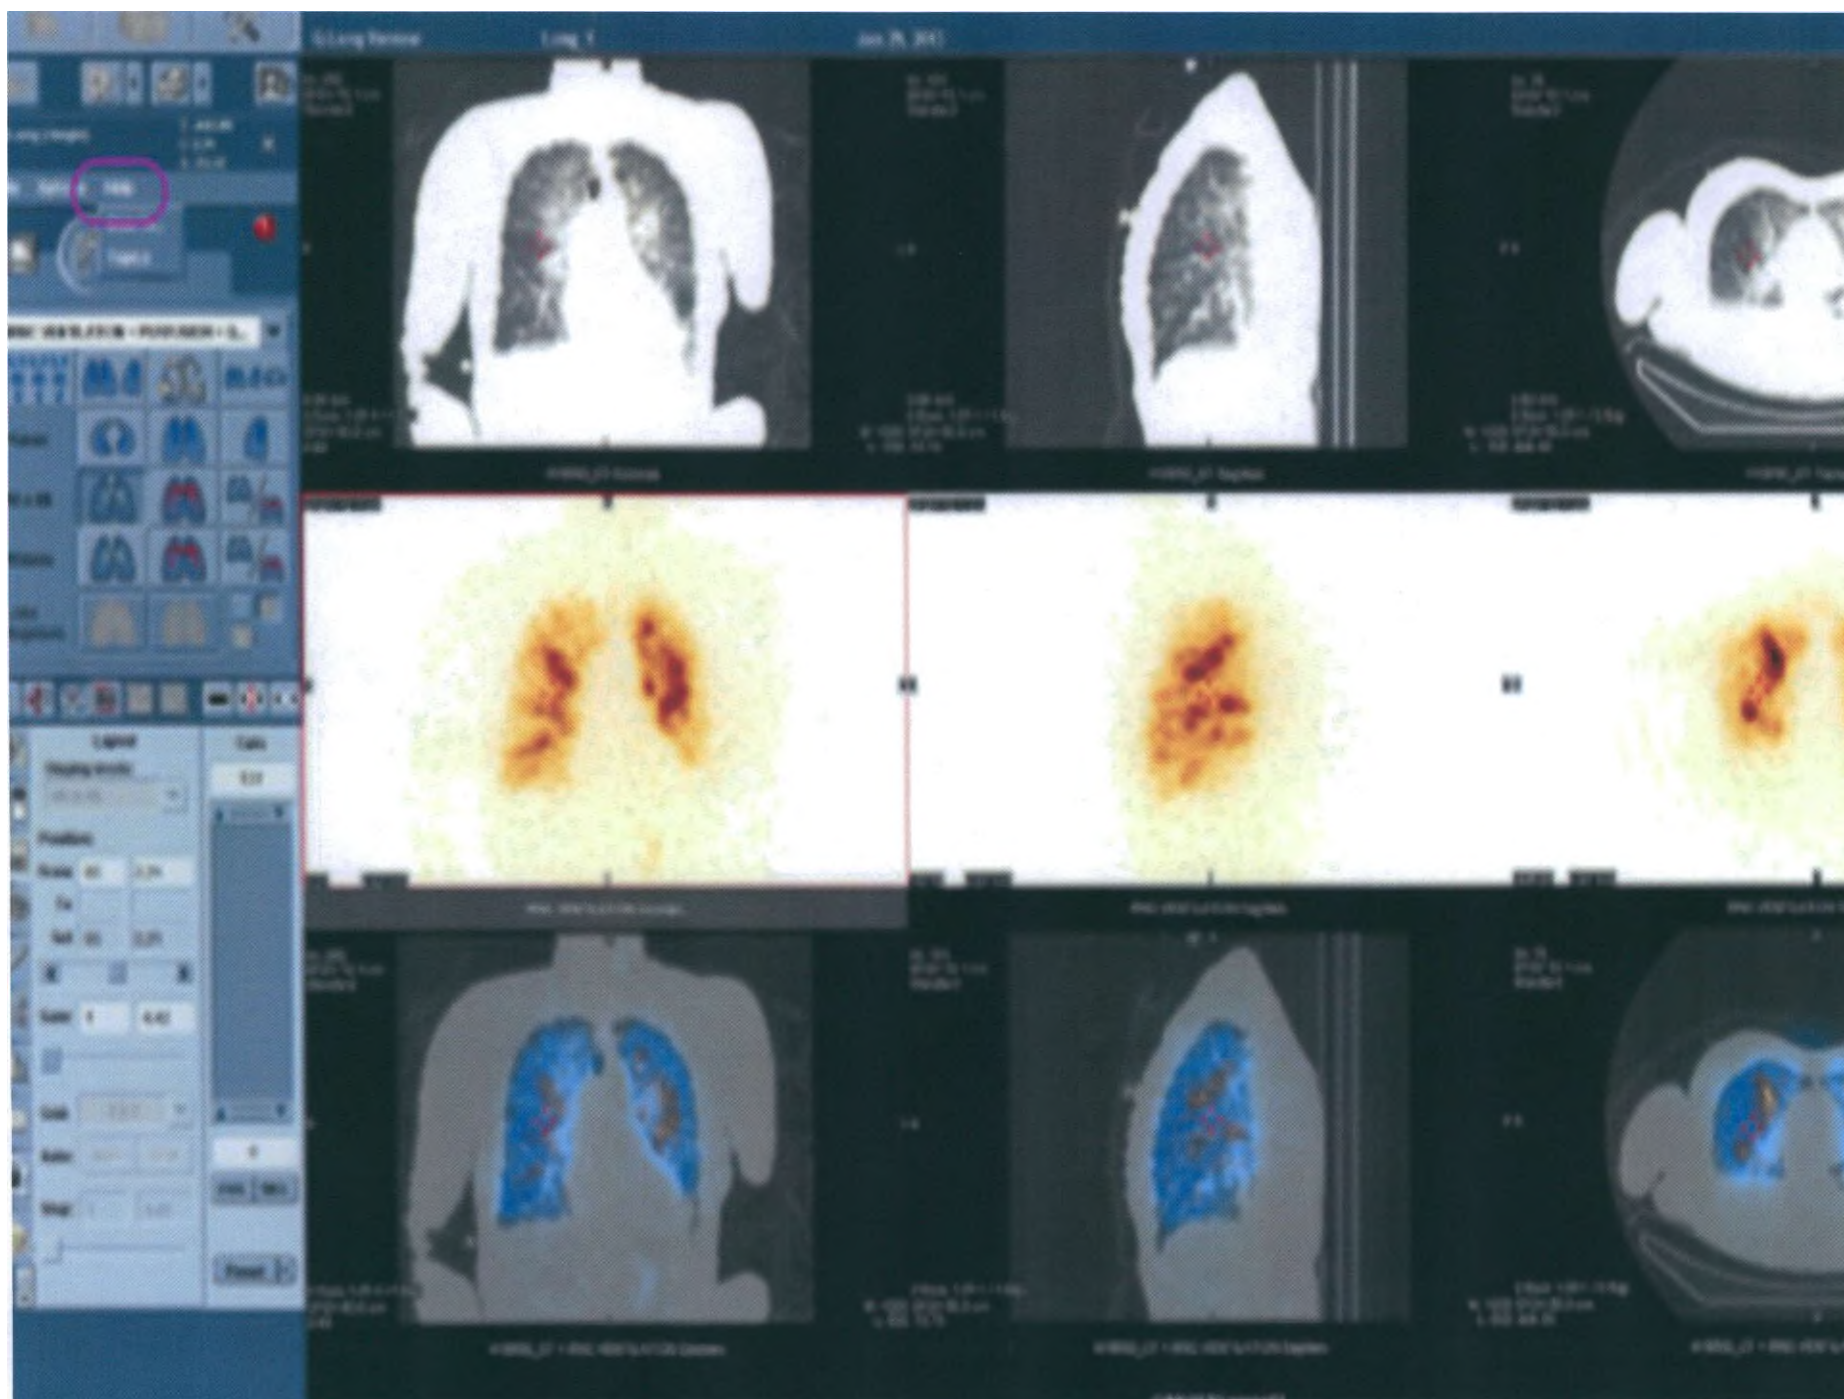

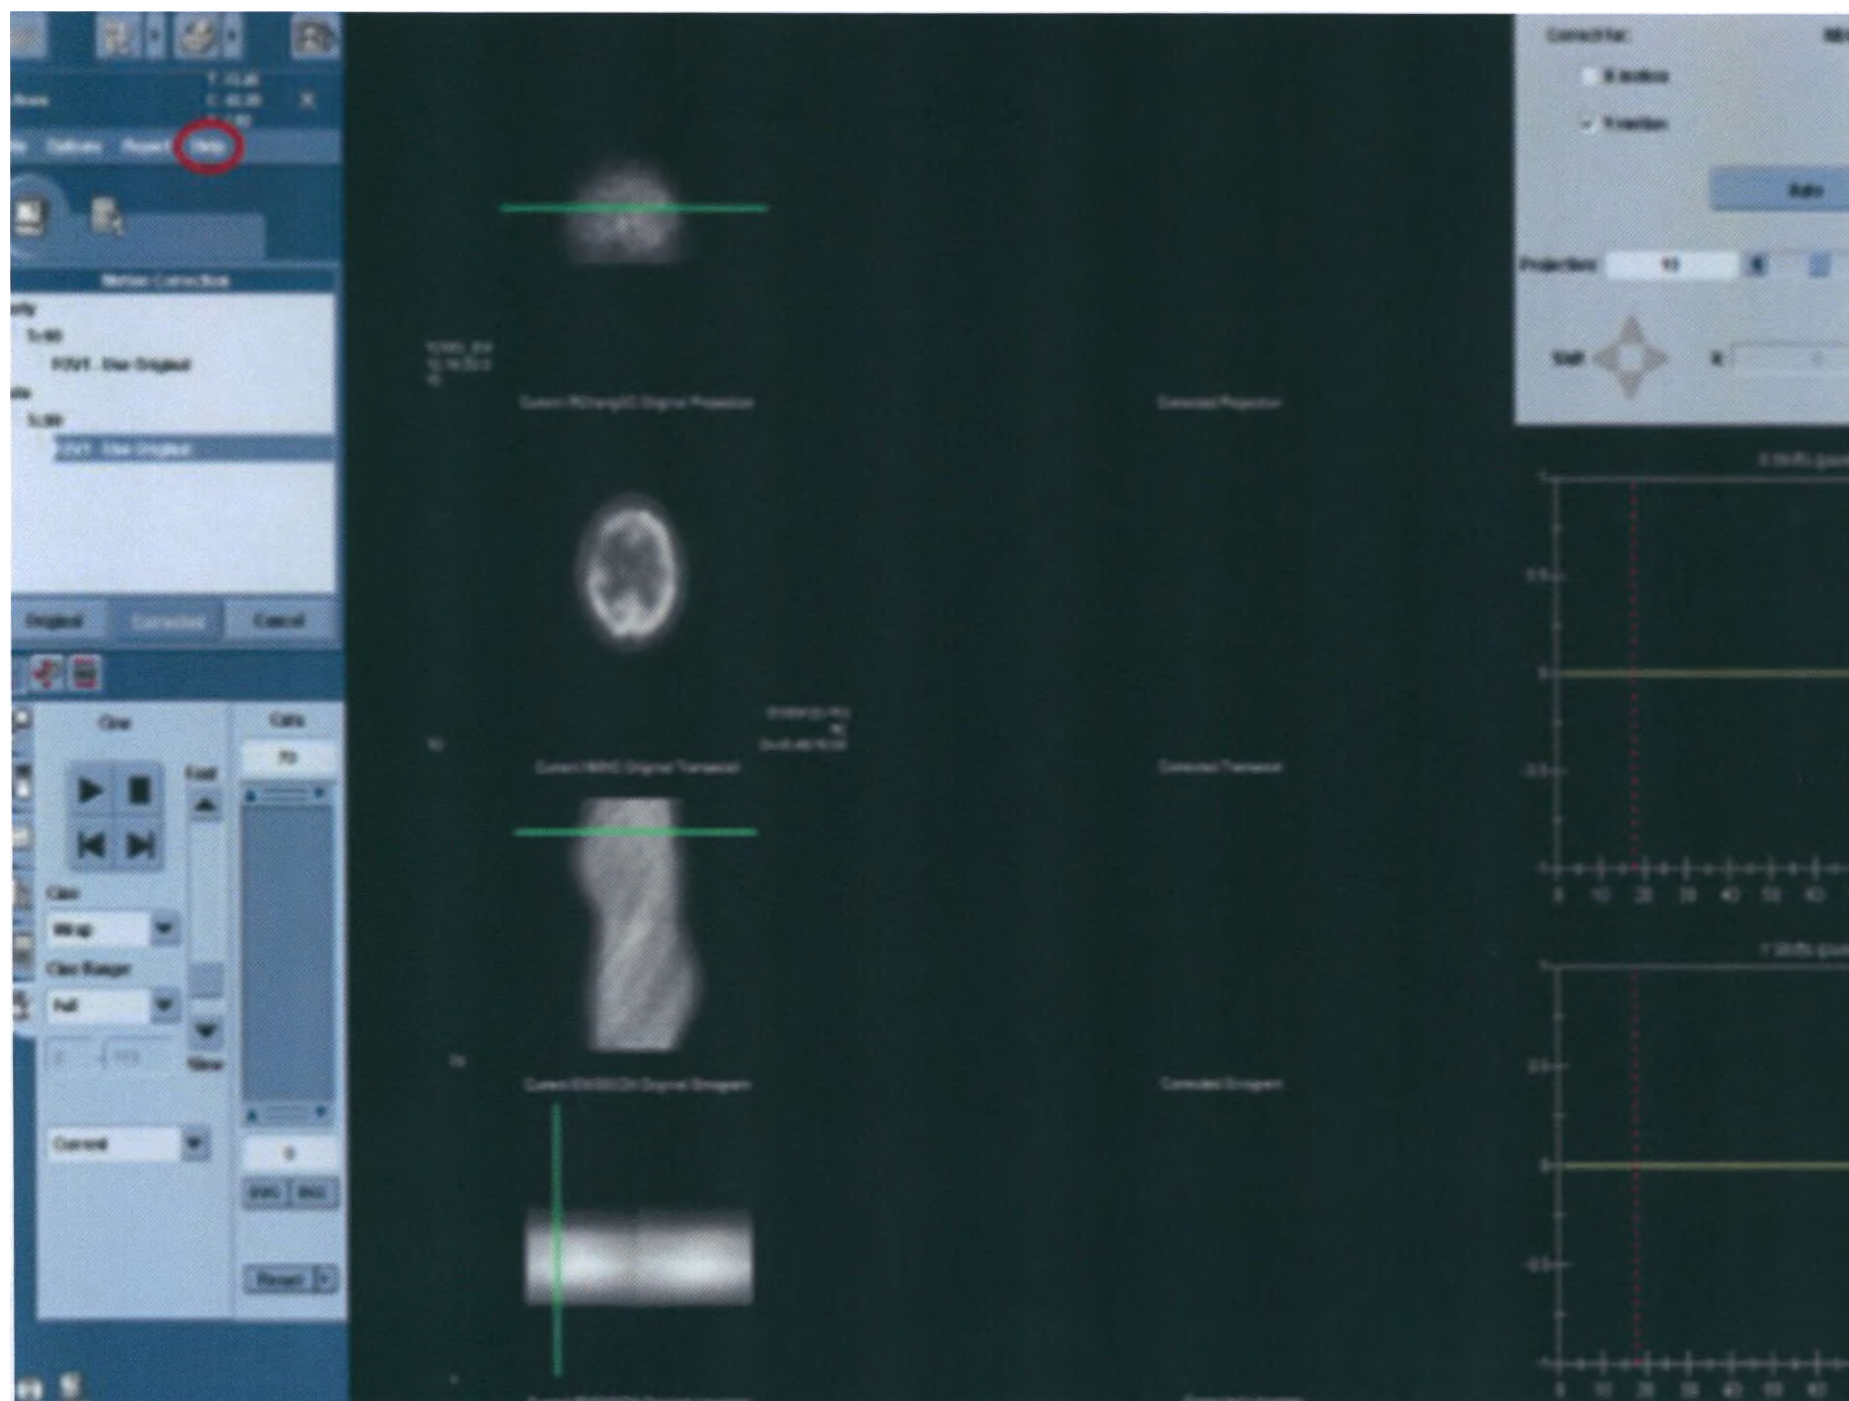










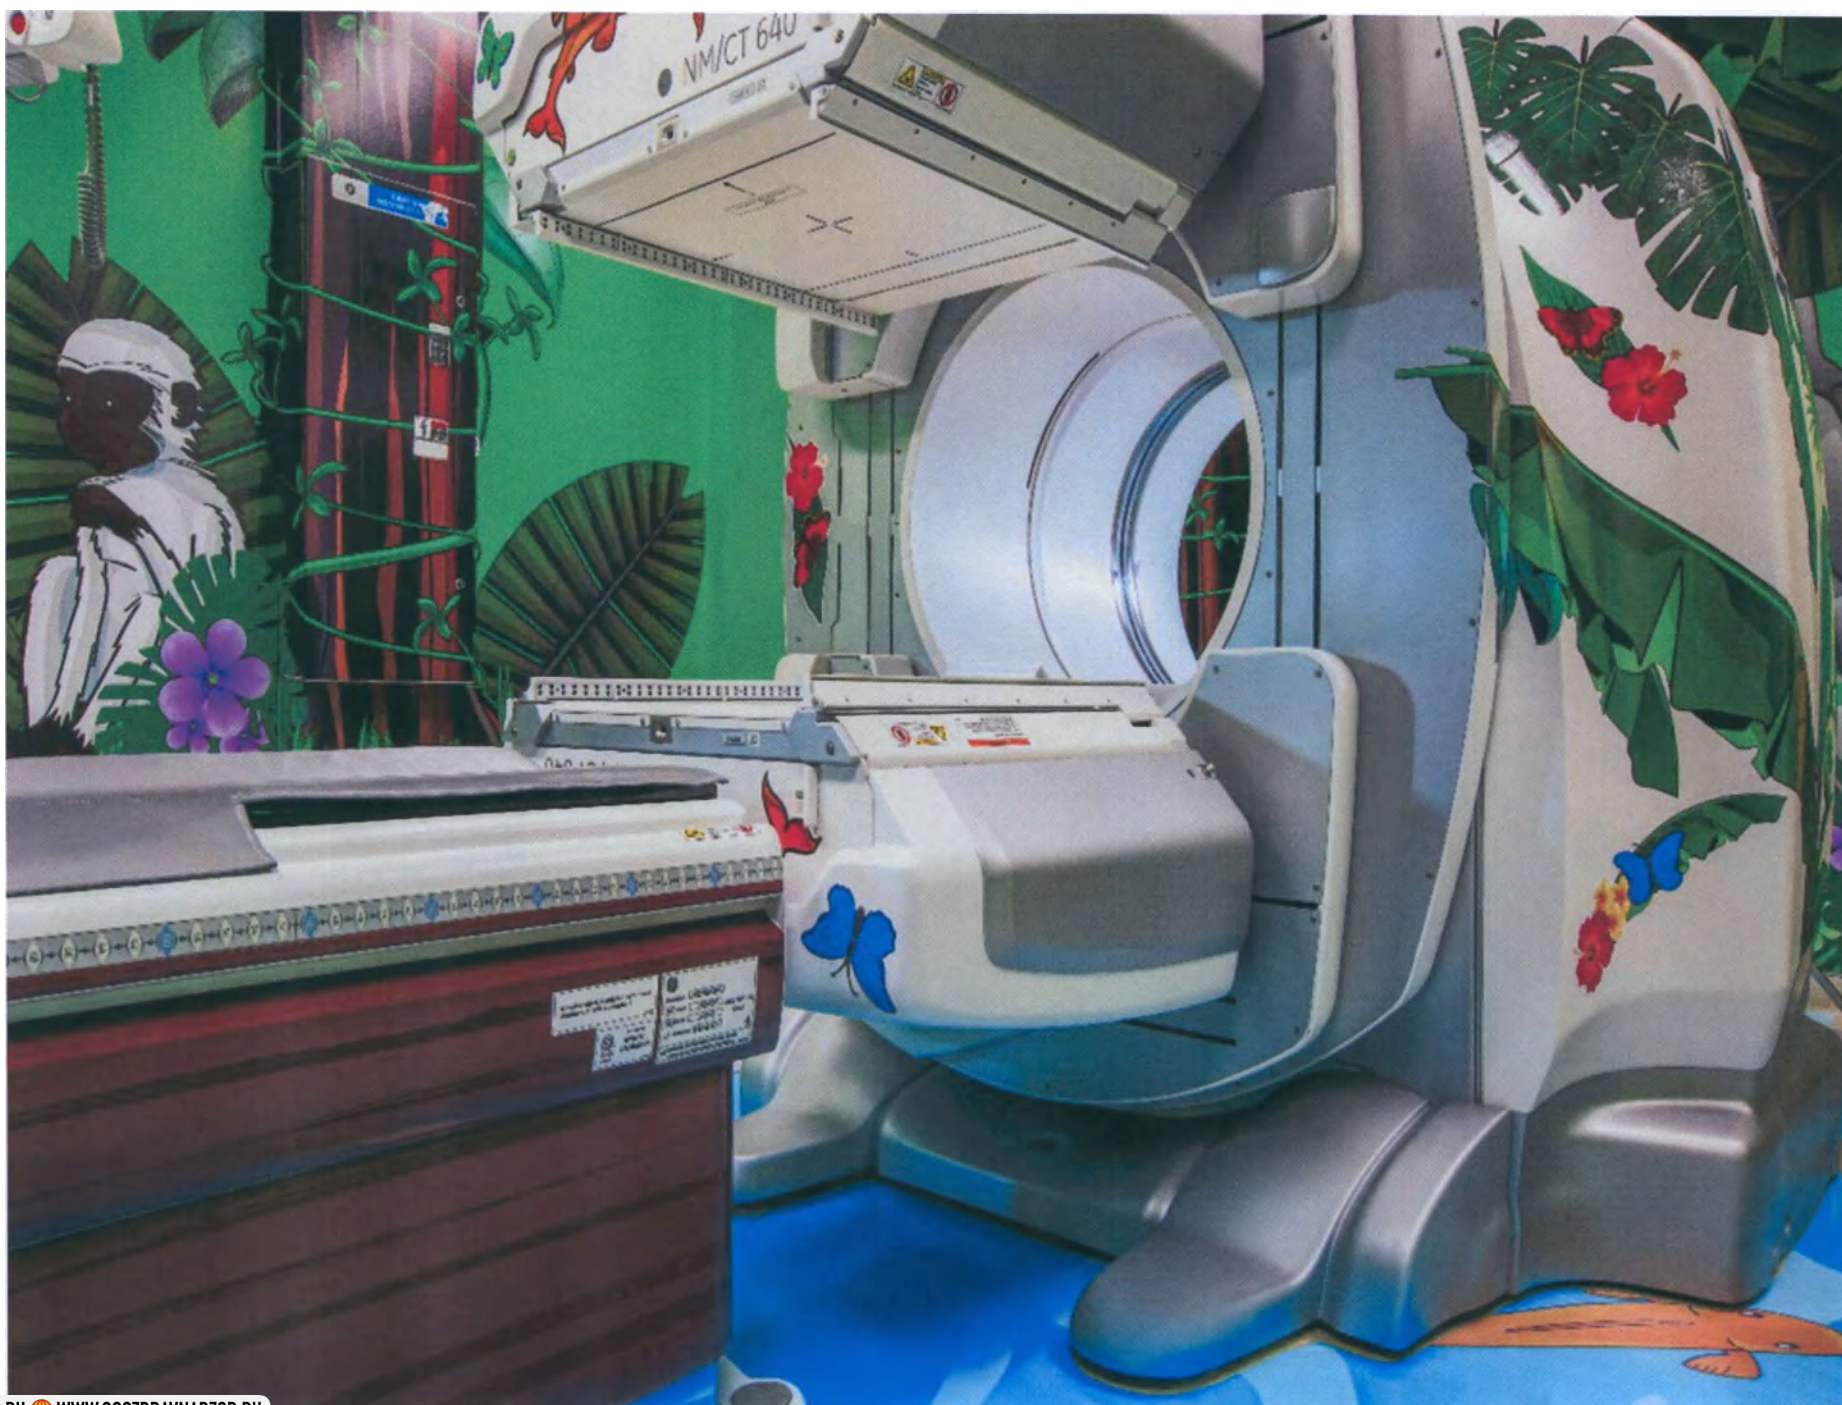





М.И. Давидов

ПРОШИТО И
СКРЕПЛЕНО
ПЕЧАТЬЮ 139 Л.