



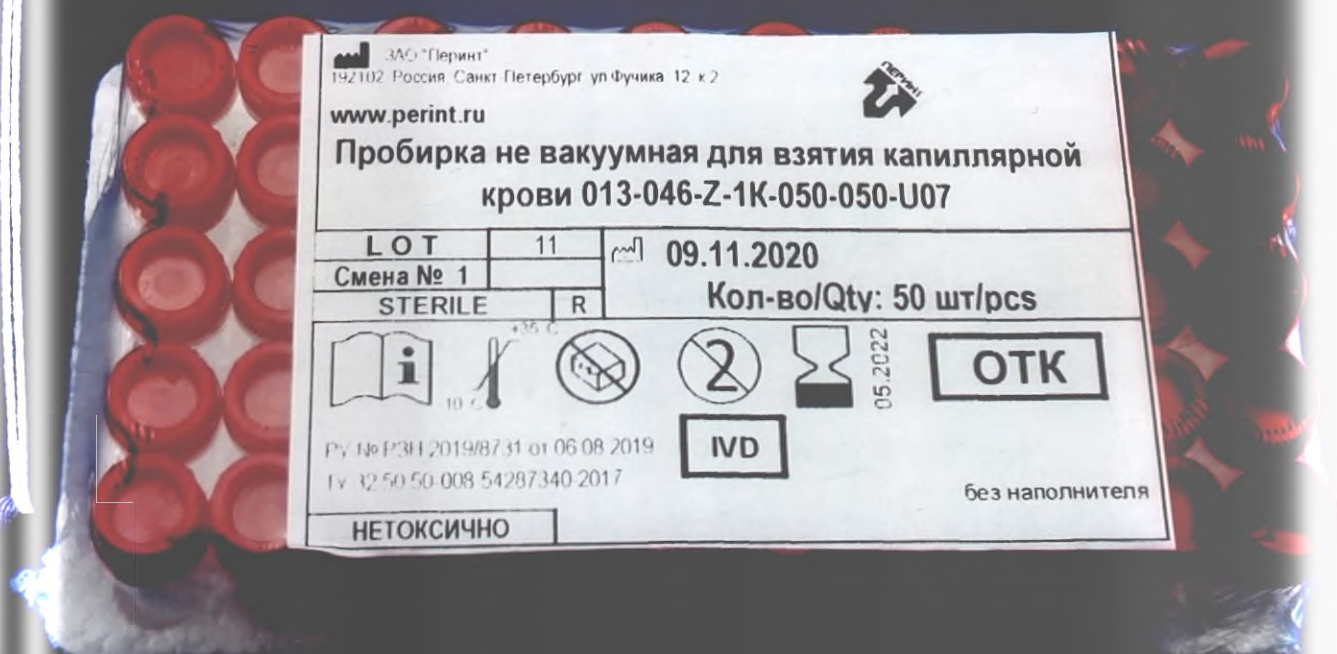

Пробирки не вакуумные для взятия капиллярной крови одноразовые по ТУ 32.50.50-008-54287340-2017

Пробирка не вакуумная для взятия капиллярной крови 013-046-Z-1K-050-050-U07 (без наполнителя, без капилляра, с одной крышкой, объем забираемой крови 0,5мл, количество в упаковке 50шт, упаковка в

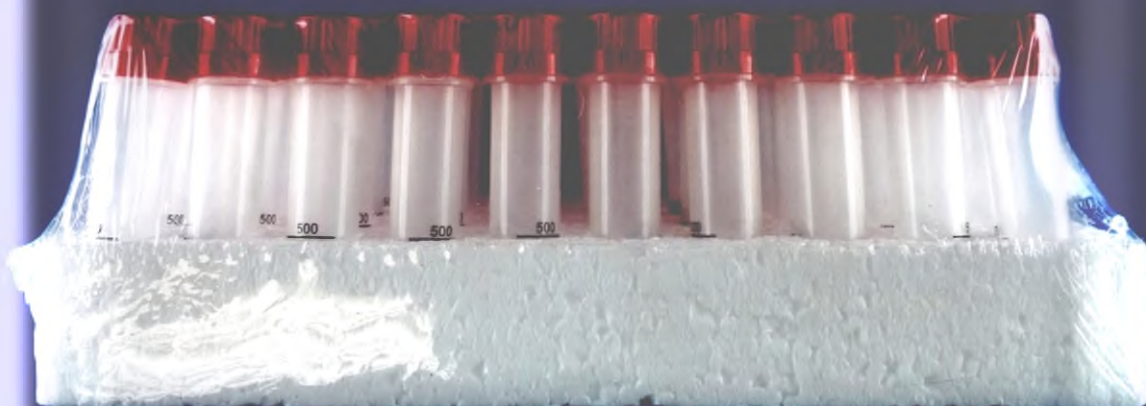

ЗАО "Перинт"

192102 Россия, Санкт Петербург ул Фучика 12 к.2



www.perint.ru

**Пробирка не вакуумная для взятия капиллярной
крови 013-046-Z-1K-050-100-U07**

LOT	11	09.11.2020
Смена № 1		Кол-во/Qty: 100 шт/pcs
STERILE	R	
		
		
РУ № РЗН 2019/В731 от 06.08.2019	IVD	05.2022
ТУ 32.50.50-008-54287340-2017		
НЕТОКСИЧНО		ОТК
		без наполнителя

пробирки не вакуумные для взятия капиллярной крови одноразовые по ТУ 32.50.50-008-54287340-2017

пробирка не вакуумная для взятия капиллярной крови 013-046-Z-1K-050-100-U07 (без наполнителя, без
капилляра, с одной крышкой, объем забираемой крови 0,5мл, количество в упаковке 100шт, упаковка в



 ЗАО "Перинт" 192102 Россия, Санкт-Петербург ул. Фучика 12 к 2 www.perint.ru			
Пробирка не вакуумная для взятия капиллярной крови 013-046-K2E-1K-050-050-U07			
LOT	11	10.11.2020	
Смена № 3		Кол-во/Qty: 50 шт/pcs	
STERILE	R		
     	ОТК		
РУ № РЗН 2019/8731 от 06.08.2019 ТУ 32.50.50-008-54287340-2017		IVD	
НЕТОКСИЧНО		наполнитель-К2ЭДТА	


Пробирки не вакуумные для взятия капиллярной крови одноразовые по ТУ 32.50.50-008-54287340-2017

Пробирка не вакуумная для взятия капиллярной крови 013-046-K2E-1K-050-050-U07 (с наполнителем К2ЭДТА, без капилляра, с одной крышкой, объем забираемой крови 0,5мл, количество в упаковке 50шт)



Пробирки не вакуумные для взятия капиллярной крови одноразовые по ТУ 32.50.50-008-54287340-2017

Пробирка не вакуумная для взятия капиллярной крови 013-046-K2E-1K-050-100-U07 (с наполнителем К2ЭДТА, без капилляра, с одной крышкой, объем забираемой крови 0,5мл, количество в упаковке 100шт.)

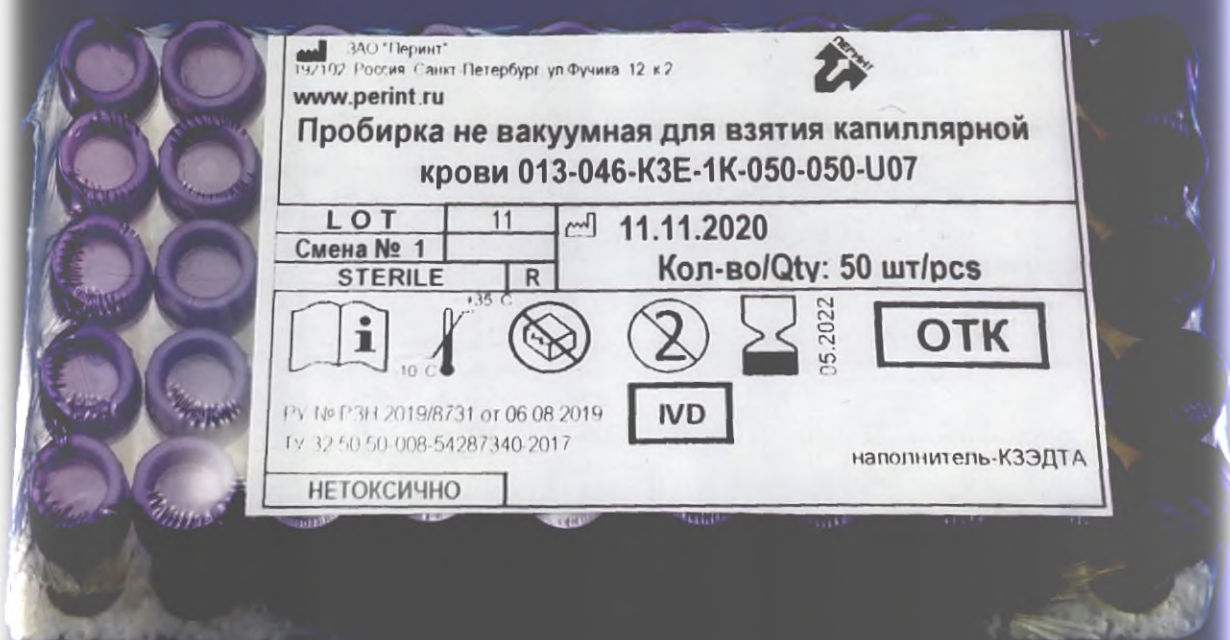

ЗАО "Перинт"
192102 Россия, Санкт-Петербург, ул. Фучика, 12 к.2
www.perint.ru



**Пробирка не вакуумная для взятия капиллярной
крови 013-046-K3E-1K-050-050-U07**

LOT	11	11.11.2020
Смена № 1		Кол-во/Qty: 50 шт/pcs
STERILE	R	








ОТК

Ру № РЗН 2019/В731 от 06.08.2019
 Ту 32.50.50-008-54287340-2017


ИВД

наполнитель-КЗЭДТА

НЕТОКСИЧНО

Пробирки не вакуумные для взятия капиллярной крови одноразовые по ТУ 32.50.50-008-54287340-2017

Пробирка не вакуумная для взятия капиллярной крови 013-046-K3E-1K-050-050-U07 (с наполнителем КЗЭДТА, без капилляра, с одной крышкой, объем забираемой крови 0,5мл, количество в упаковке 50шт.

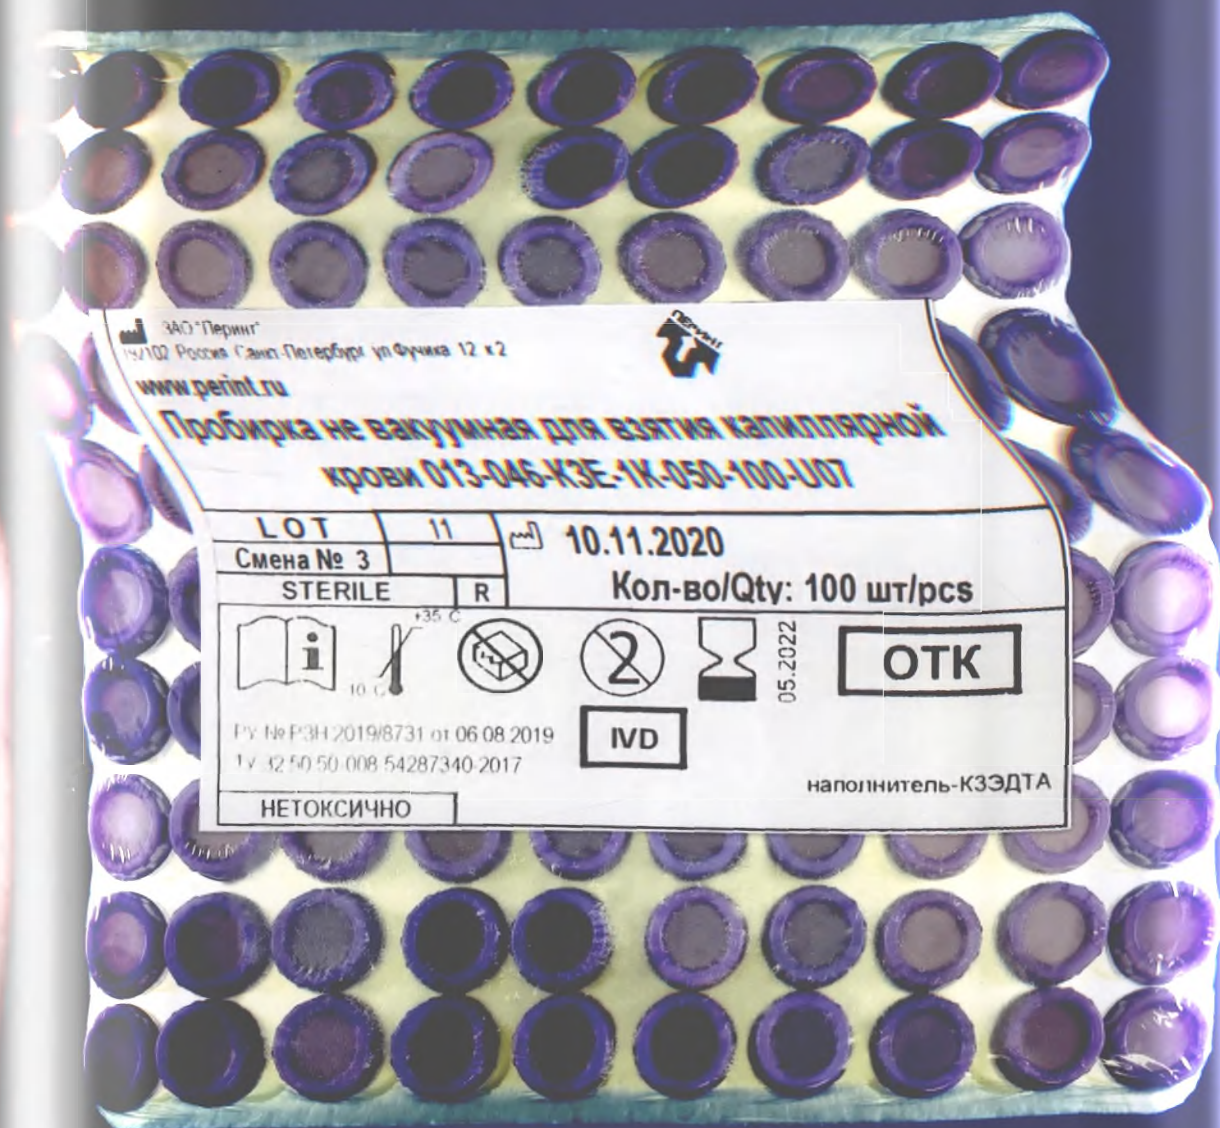

ЗАО "Перинт"
197102 Россия Санкт-Петербург ул. Фучика 12 к2
www.perint.ru



**Пробирка не вакуумная для взятия капиллярной
крови 013-046-K3E-1K-050-100-U07**

LOT 11		10.11.2020	
Смена № 3		Кол-во/Qty: 100 шт/pcs	
STERILE R			
ГТУ № РЗН 2019/8731 от 06.08.2019		05.2022	
ТУ 32.50.50-008-54287340-2017		ОТК	
НЕТОКСИЧНО		наполнитель-КЗЭДТА	




не вакуумные для взятия капиллярной крови одноразовые по ТУ 32.50.50-008-54287340-2017.



 ЗАО "Перинт"
 192102 Россия Санкт-Петербург ул. Фучика 12 к 2
www.perint.ru





**Пробирка не вакуумная для взятия капиллярной
 крови 013-046-К3Е-1К-050-100-U07**

LOT	11	10.11.2020
Смена № 3		Кол-во/Qty: 100 шт/pcs
STERILE	R	
     		05.2022
РУ № РЗН 2019/8731 от 06.08.2019 ТУ 32.50.50-008-54287340-2017		наполнитель-КЗЭДТА
НЕТОКСИЧНО		

Пробирки не вакуумные для взятия капиллярной крови одноразовые по ТУ 32.50.50-008-54287340-2017

Пробирка не вакуумная для взятия капиллярной крови 013-046-К3Е-1К-050-100-U07 (с наполнителем КЗЭДТА, без капилляра, с одной крышкой, объем забираемой крови 0,5мл, количество в упаковке 100шт)

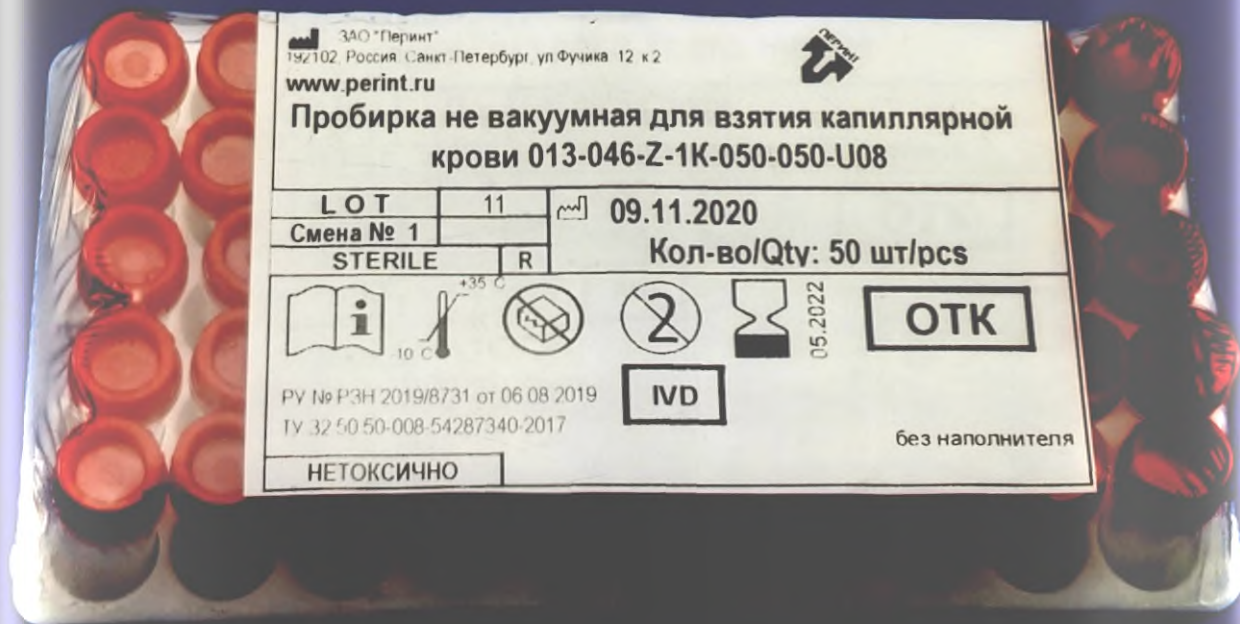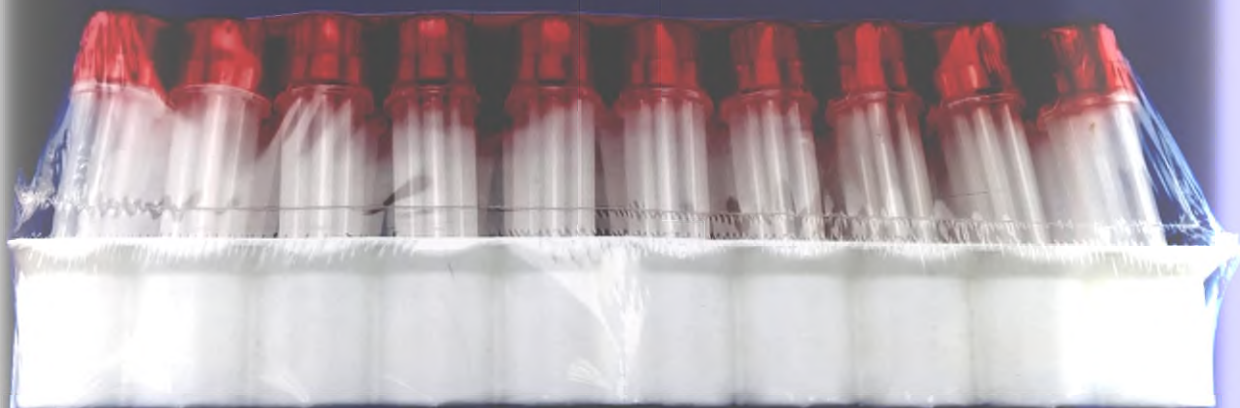


ЗАО "Перинт"
192102 Россия, Санкт-Петербург, ул. Фучика 12 к 2
www.perint.ru



Пробирка не вакуумная для взятия капиллярной крови 013-046-Z-1K-050-050-U08

LOT	11	09.11.2020
Смена № 1		
STERILE	R	Кол-во/Qty: 50 шт/pcs



05.2022

ОТК

РУ № РЗН 2019/В731 от 06.08.2019
ТУ 32.50.50-008-54287340-2017


IVD

без наполнителя

НЕТОКСИЧНО


Пробирки не вакуумные для взятия капиллярной крови одноразовые по ТУ 32.50.50-008-54287340-2017.

Пробирка не вакуумная для взятия капиллярной крови 013-046-Z-050-050-U08 (без наполнителя, без капилляра, с одной крышкой, объем забираемой крови 0,5мл, количество в упаковке 50шт, упаковка в

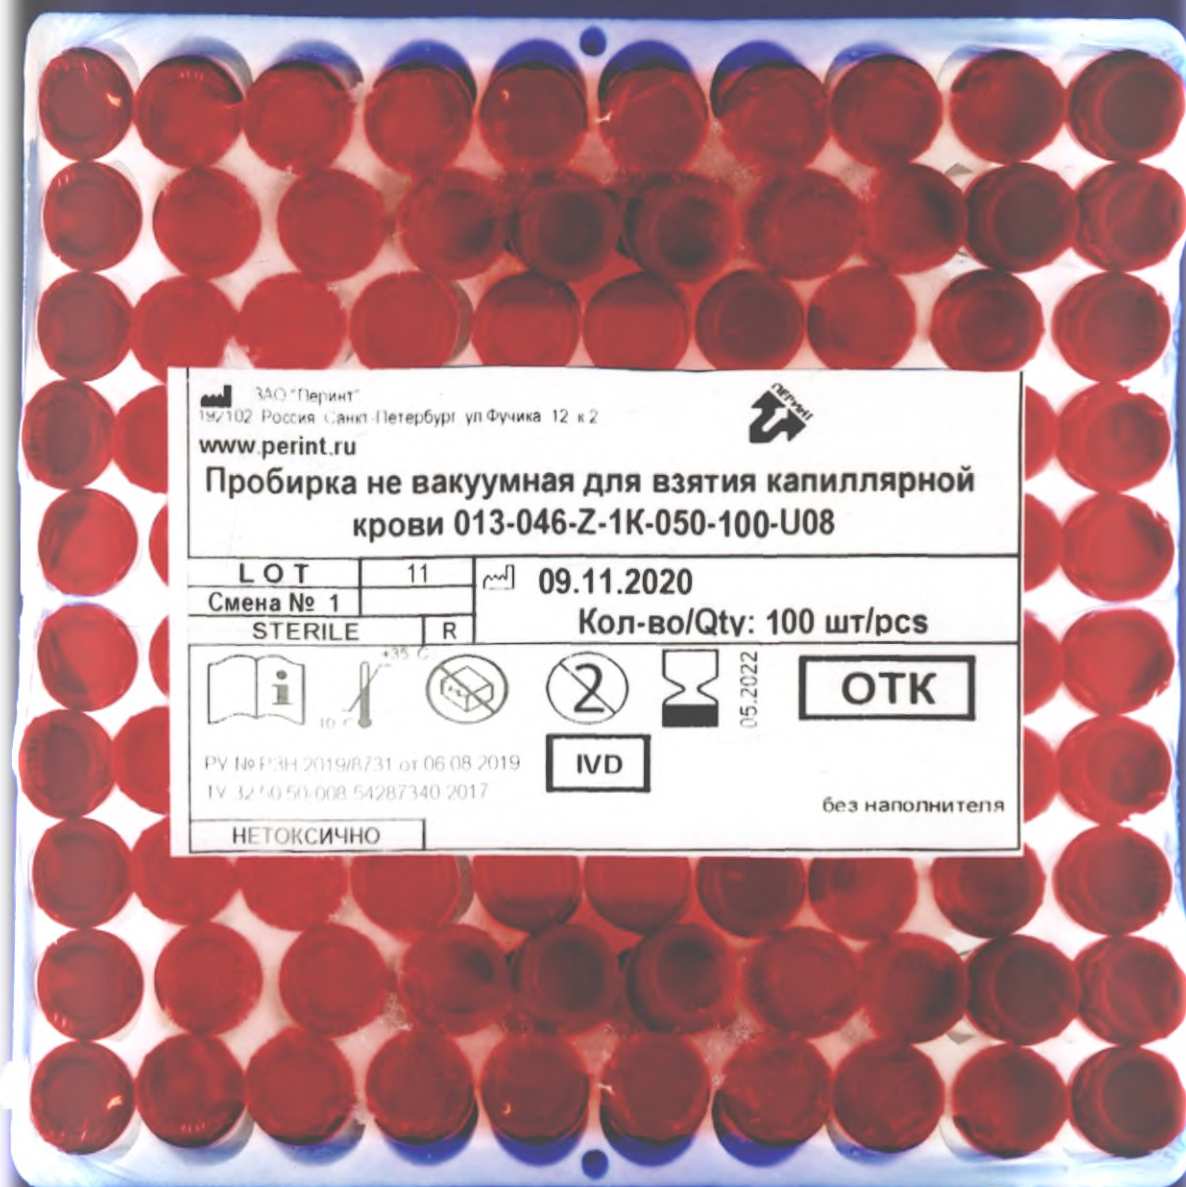

Пробирки не вакуумные для взятия капиллярной крови одноразовые по ТУ 32.50.50-008-54287340-2017

Пробирка не вакуумная для взятия капиллярной крови 013-046-Z-050-100-U08 (без наполнителя, без
 крышки, с одной крышкой, объем забираемой крови 0,5мл, количество в упаковке 100шт, упаковка В

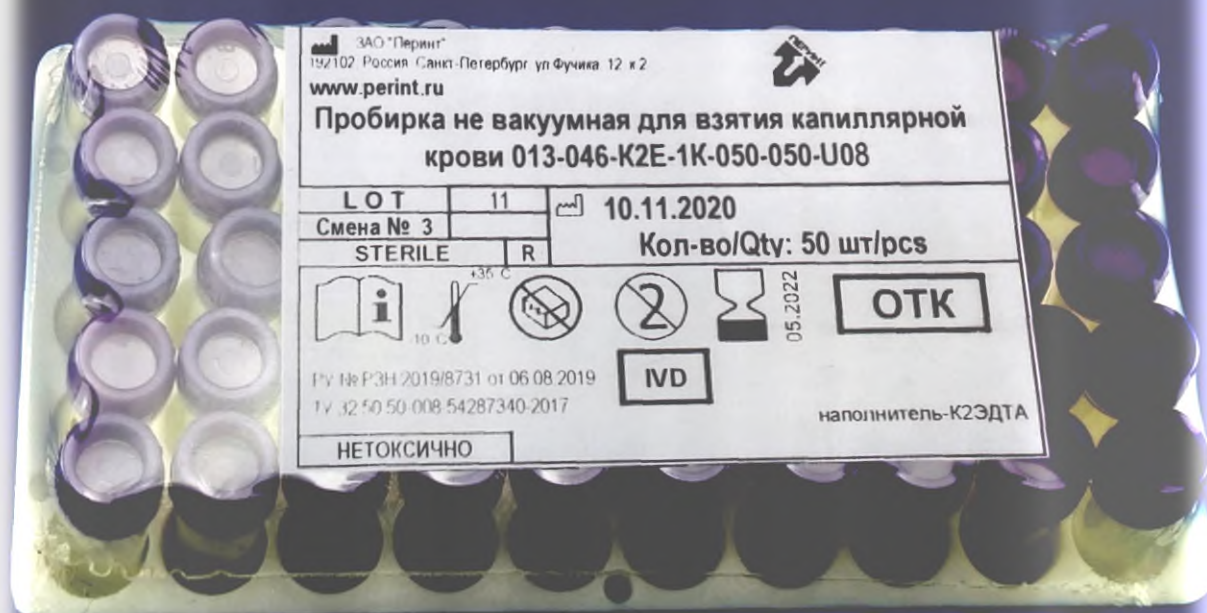

Пробирки не вакуумные для взятия капиллярной крови одноразовые по ТУ 32.50.50-008-54287340-2017


Пробирка не вакуумная для взятия капиллярной крови 013-046-K2E-1K-050-050-U08 (с наполнителем К2ЭДТА, без капилляра, с одной крышкой, объем забираемой крови 0,5мл, количество в упаковке 50шт)



 ЗАО "Перинт" 192102 Россия Санкт-Петербург ул. Фучика 12 к 2 www.perint.ru			
Пробирка не вакуумная для взятия капиллярной крови 013-046-K2E-1K-050-100-U08			
LOT	11	10.11.2020	
Смена № 3		Кол-во/Qty: 100 шт/pcs	
STERILE	R		
     	ОТК		
Ру № РЗН 2019/8731 от 06.08.2019 Ту 32.50.50.008.54287340-2017		IVD	
НЕТОКСИЧНО		наполнитель-К2ЭДТА	


пробирки не вакуумные для взятия капиллярной крови одноразовые по ТУ 32.50.50-008-54287340-2017

пробирка не вакуумная для взятия капиллярной крови 013-046-K2E-1K-050-100-U08 (с наполнителем К2ЭДТА, без капилляра, с одной крышкой, объем забираемой крови 0,5мл, количество в упаковке 100шт)

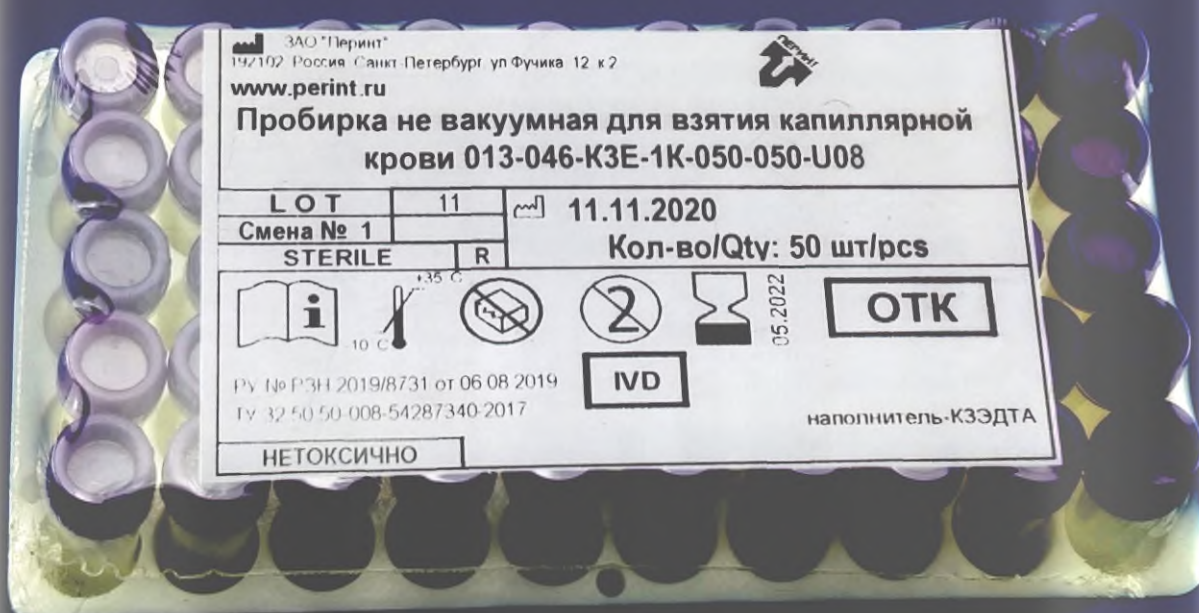

пробирки не вакуумные для взятия капиллярной крови одноразовые по ТУ 32.50.50-008-54287340-2017

пробирка не вакуумная для взятия капиллярной крови 013-046-КЗЕ-1К-050-050-U08 (с наполнителем КЗЭДТА, без капилляра, с одной крышкой, объем забираемой крови 0,5мл, количество в упаковке 50шт.

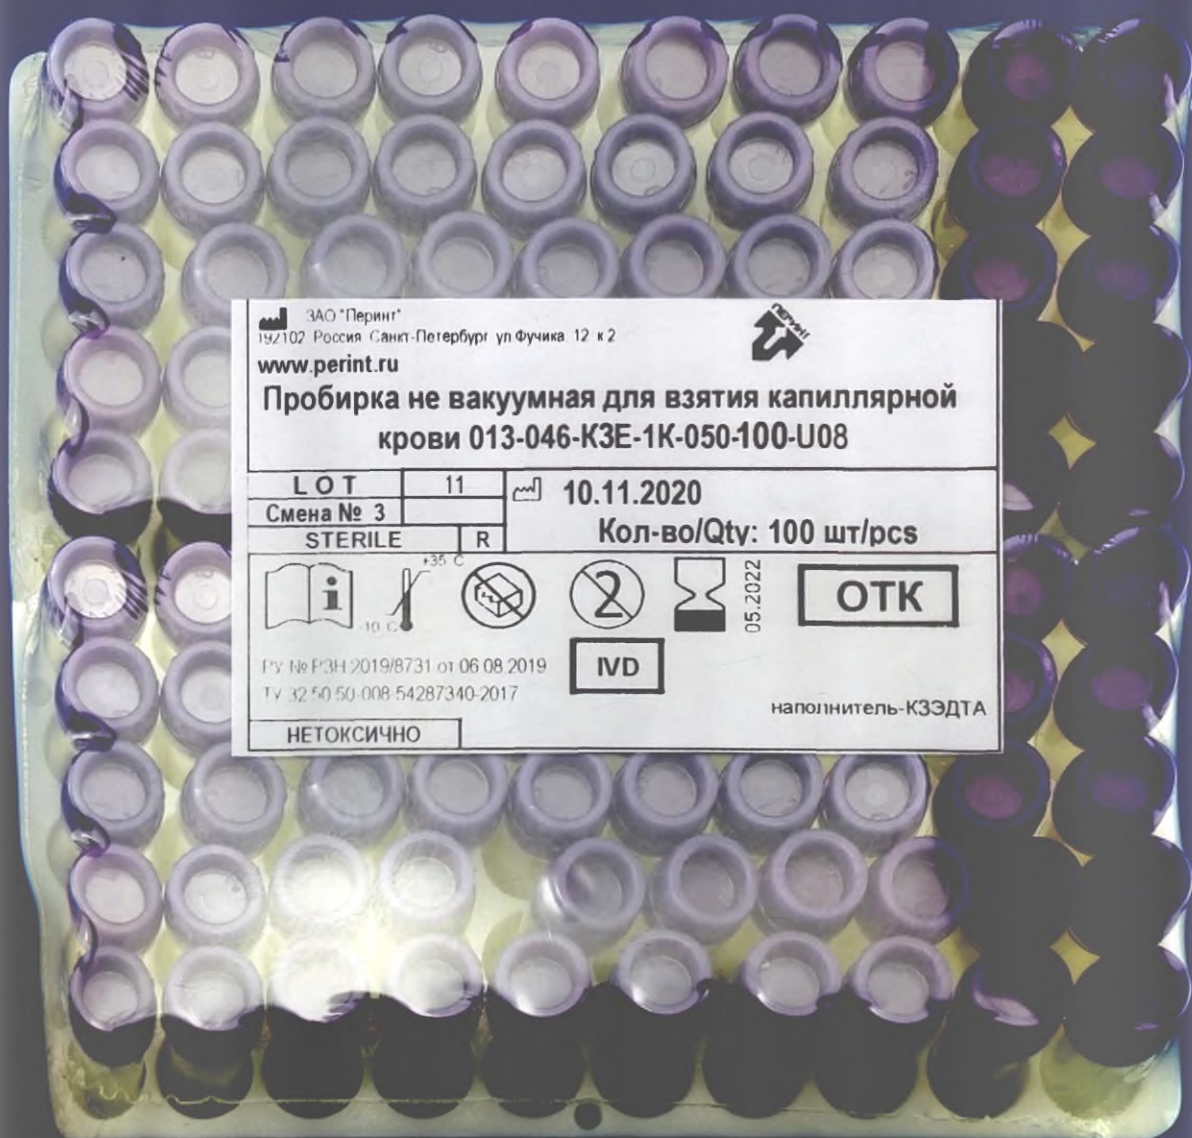

 ЗАО "Перинт" 192102 Россия Санкт-Петербург ул. Фучика 12 к 2 www.perint.ru			
Пробирка не вакуумная для взятия капиллярной крови 013-046-K3E-1K-050-100-U08			
LOT	11	10.11.2020	
Смена № 3		Кол-во/Qty: 100 шт/pcs	
STERILE	R		
     	ОТК		
Ру № РЗН 2019/8731 от 06.08.2019 Ту 32.50.50.008-54287340-2017		IVD	
НЕТОКСИЧНО		наполнитель-КЗЭДТА	


вакуумные для взятия капиллярной крови одноразовые по ТУ 32.50.50-008-54287340-2017

вакуумная для взятия капиллярной крови 013-046-K3E-1K-050-100-U08 (с наполнителем
капилляра, с одной крышкой, объем забираемой крови 0,5мл, количество в упаковке 100шт.





пробирки не вакуумные для взятия капиллярной крови одноразовые по ТУ 32.50.50-008-54287340-2017.

пробирка не вакуумная для взятия капиллярной крови 013-046-Z-2K-050-020-U09 (без наполнителя, с капилляром, с двумя крышками, объем забираемой крови 0,5мл, количество в упаковке 20шт, упаковка в

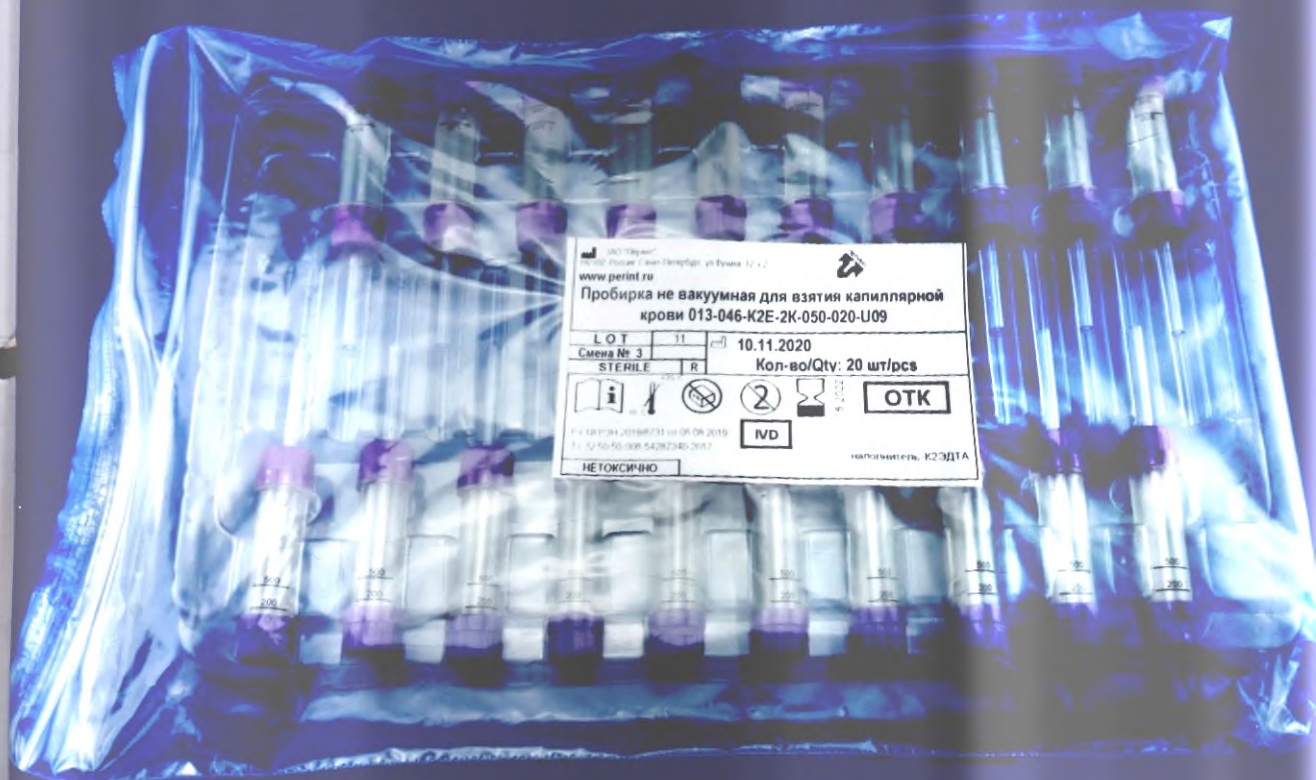

пробирки не вакуумные для взятия капиллярной крови одноразовые по ТУ 32.50.50-008-54287340-2017.

пробирка не вакуумная для взятия капиллярной крови 013-046-K2E-2K-050-020-U09 (с наполнителем К2ЭДТА, с капилляром, с двумя крышками, объем забираемой крови 0,5мл, количество в упаковке 20шт,

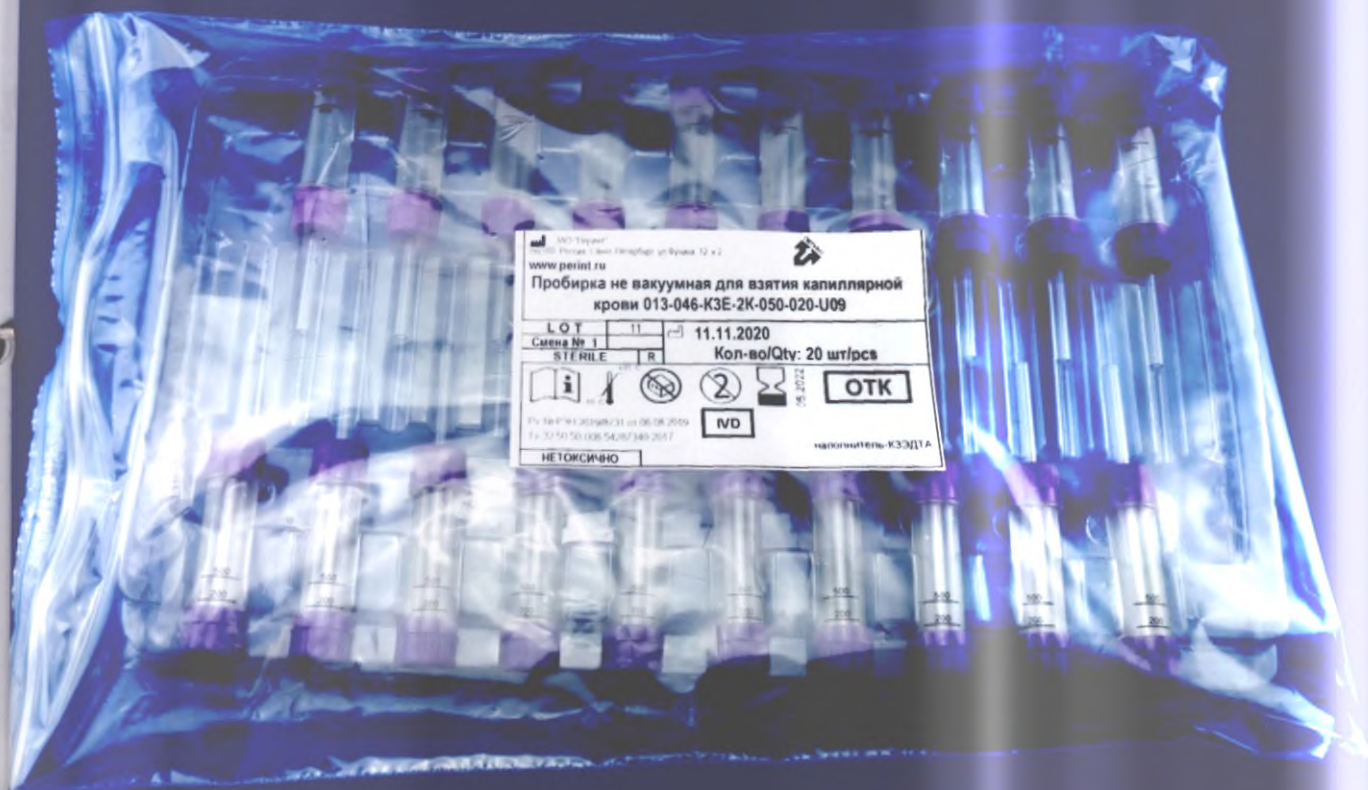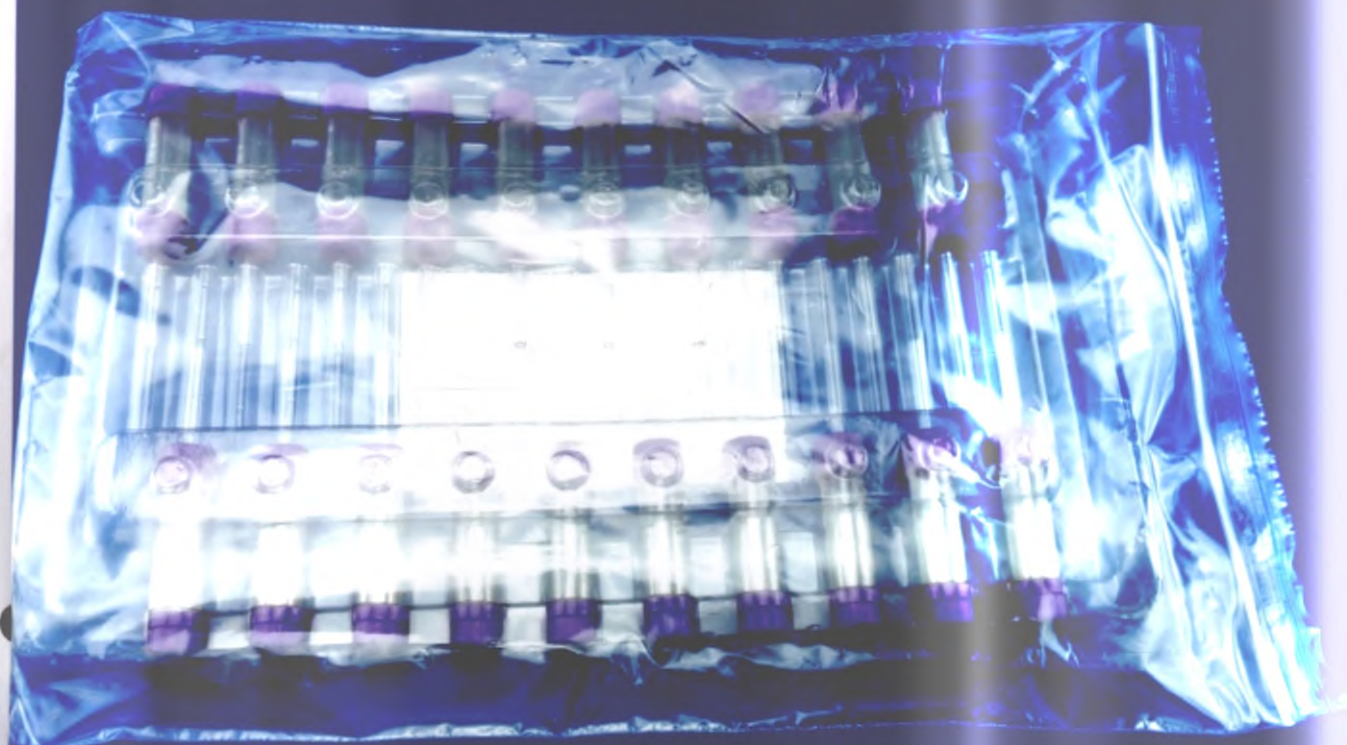

Пробирки не вакуумные для взятия капиллярной крови одноразовые по ТУ 32.50.50-008-54287340-2017.

Пробирка не вакуумная для взятия капиллярной крови 013-046-КЗЕ-2К-050-020-U09 (с наполнителем КЗЭДТА, с капилляром, с двумя крышками, объем забираемой крови 0,5мл, количество в упаковке 20шт.

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью ЗАО «Перинт» 15 л.

(шестнадцать)

Генеральный директор ЗАО «Перинт»

М.Я. Моносов

