

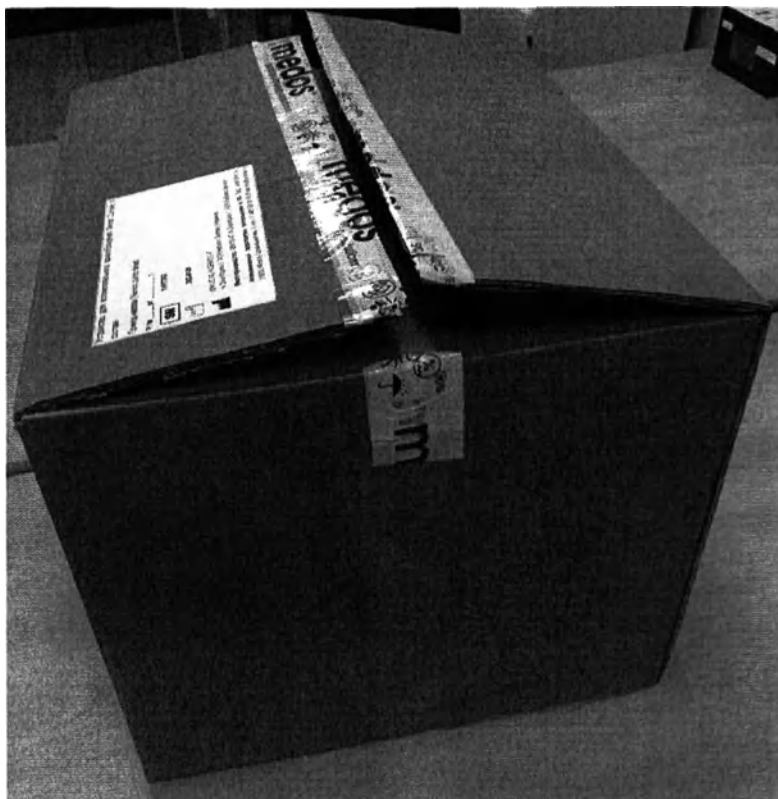


Фото 3- Привод насоса (Xenios pump drive) – внешний вид упаковки

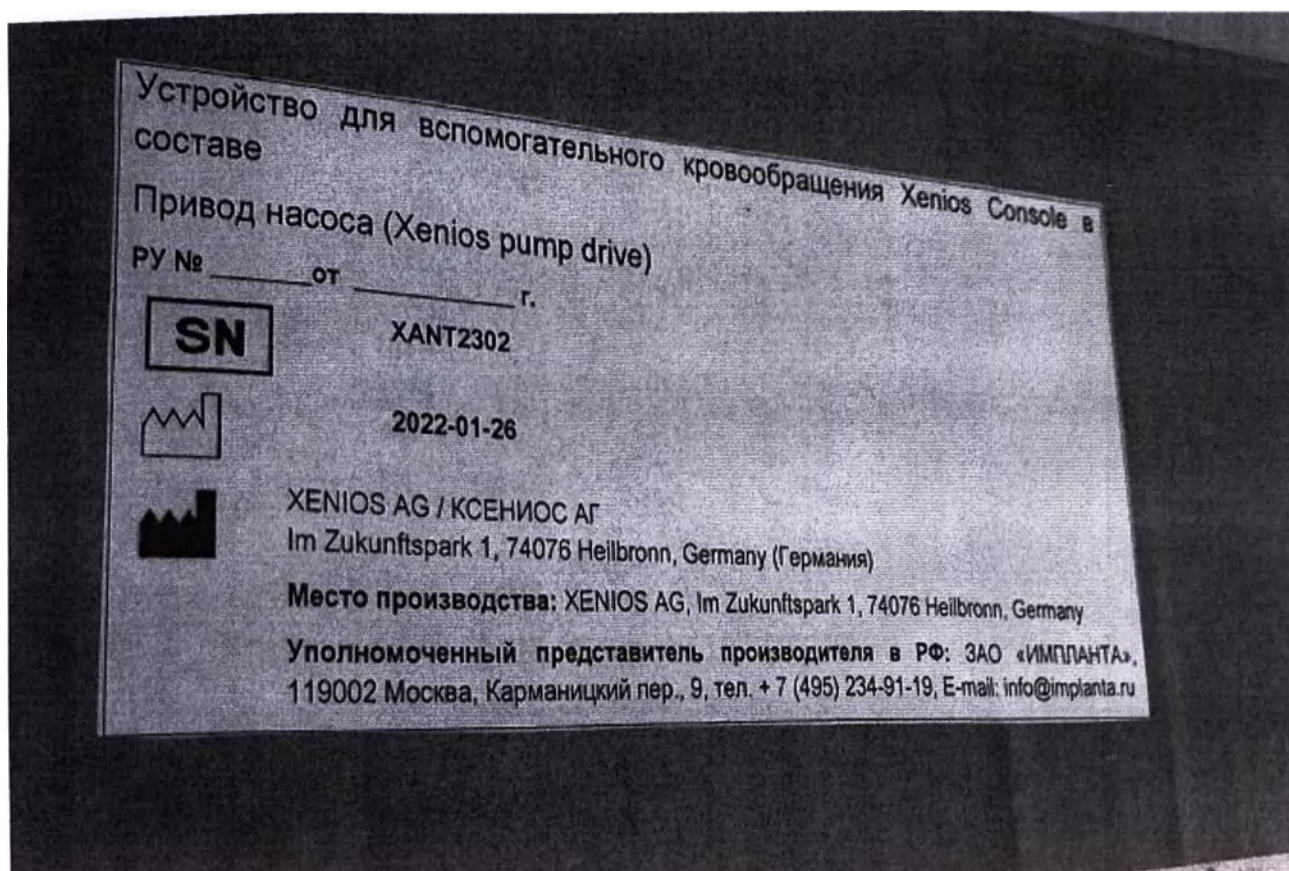


Фото 4- Привод насоса (Xenios pump drive) – маркировка упаковки



ООО Испытательный лабораторный центр «МедТестПрибор»
Аттестат аккредитации: РОСС RU.0001.21МП26 от 22.07.2015



Фото 5 - Привод насоса (Xenios pump drive) – внешний вид образца

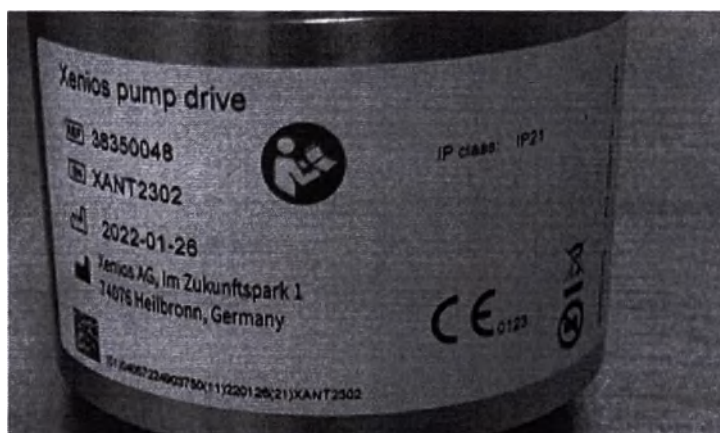


Фото 6 - Привод насоса (Xenios pump drive) – маркировка образца


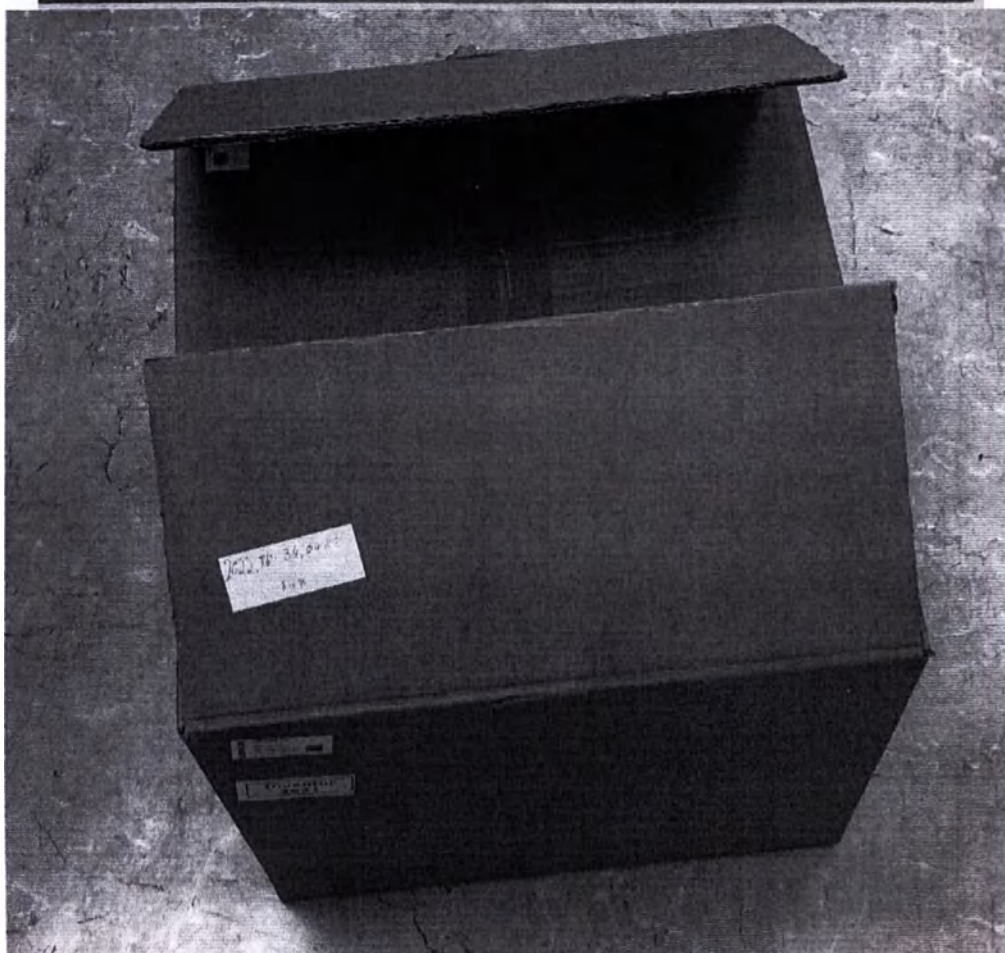


Фото 7- Блок датчиков (Xenios sensor box) – внешний вид и маркировка упаковки

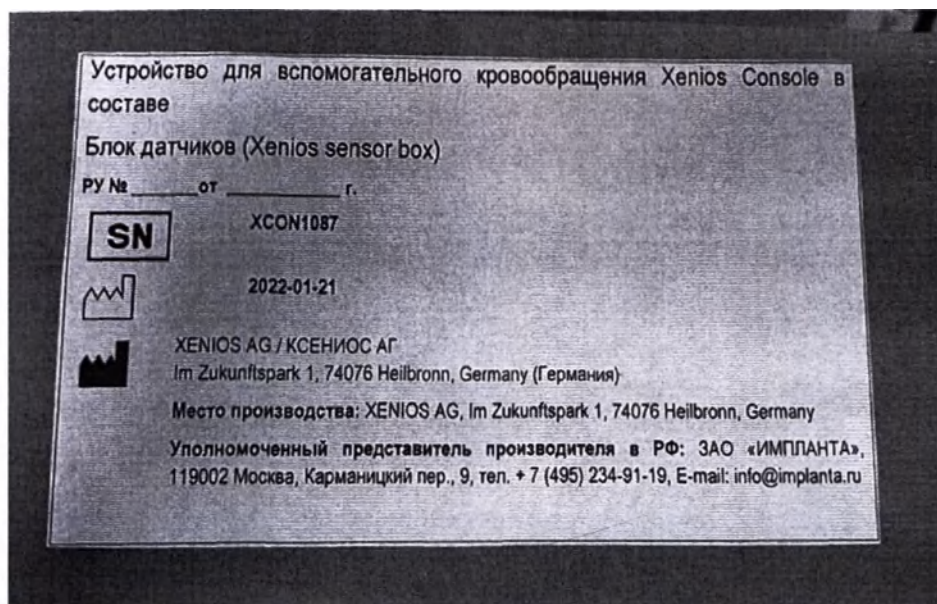

ООО Испытательный лабораторный центр «МедТестПрибор»
Аттестат аккредитации: РОСС RU.0001.21МП26 от 22.07.2015


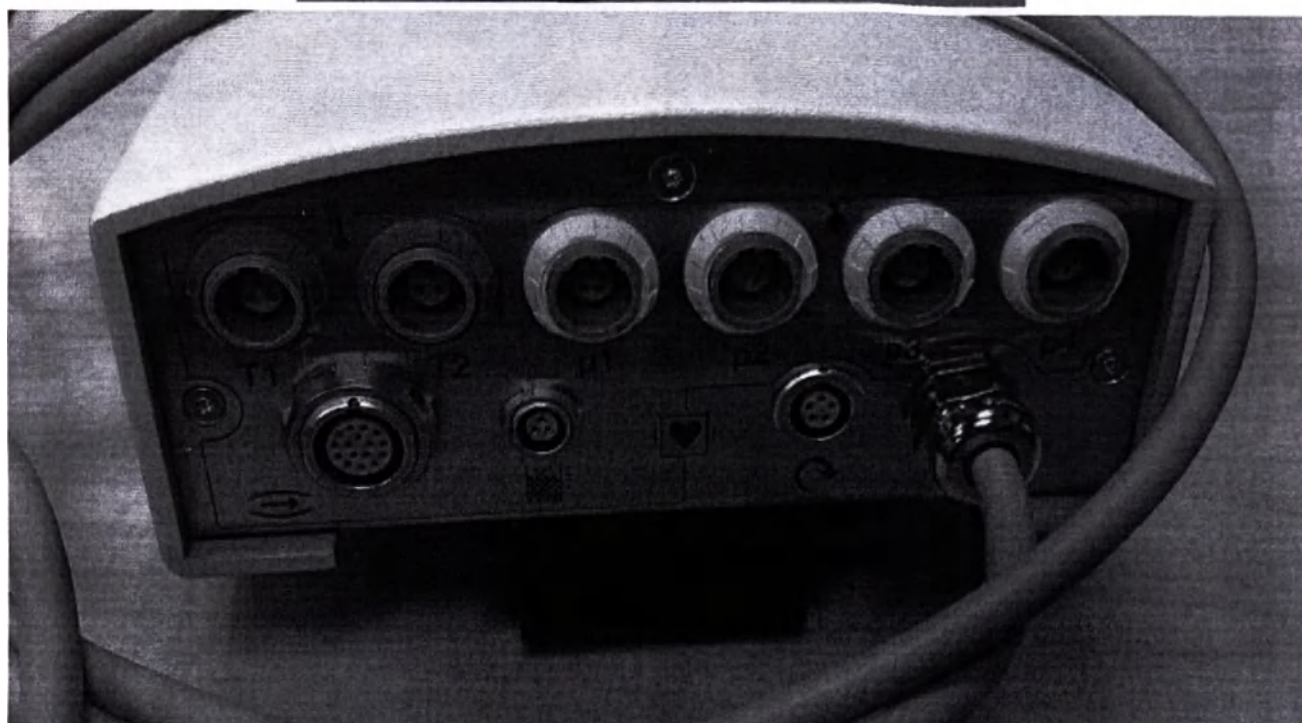


Фото 8 - Блок датчиков (Xenios sensor box) – внешний вид образца

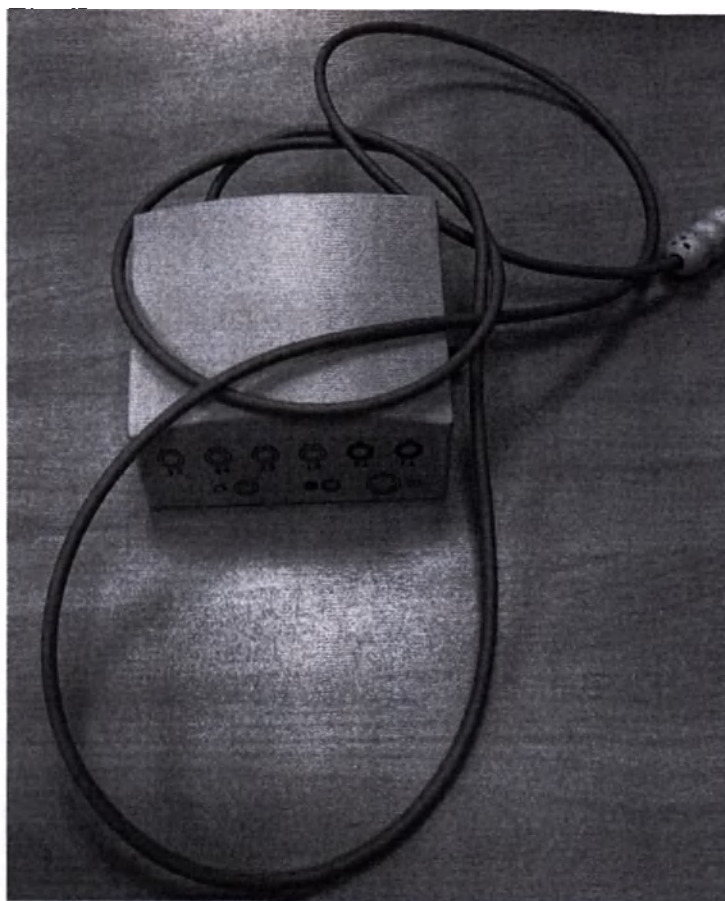

ООО Испытательный лабораторный центр «МедТестПрибор»
Аттестат аккредитации: РОСС RU.0001.21МП26 от 22.07.2015



Фото 9 - Блок датчиков (Xenios sensor box) – маркировка образца



Фото 10 - Блок питания (Xenios power supply) – внешний вид упаковки

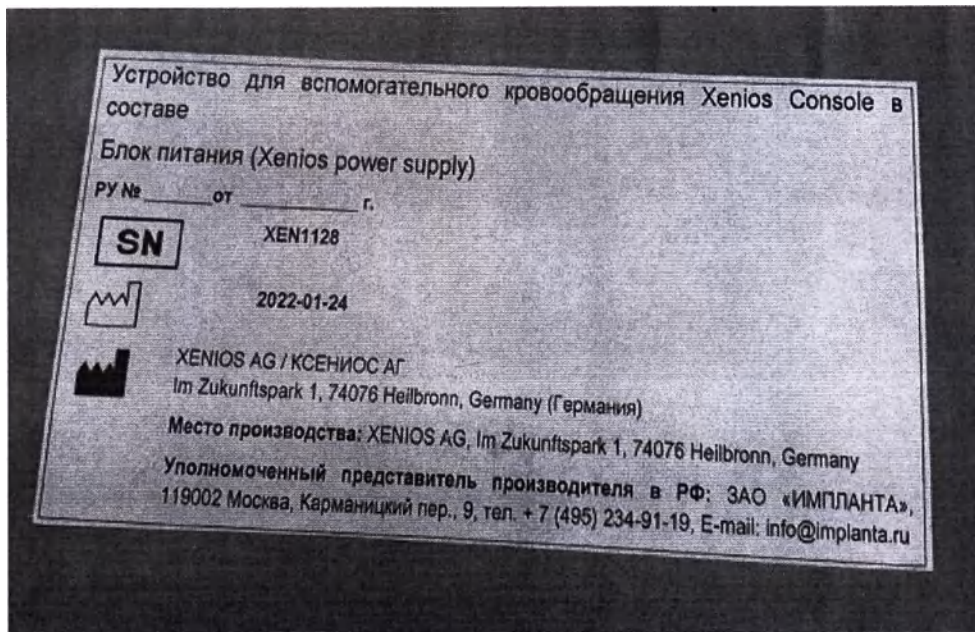


Фото 11 - Блок питания (Xenios power supply) – маркировка упаковки

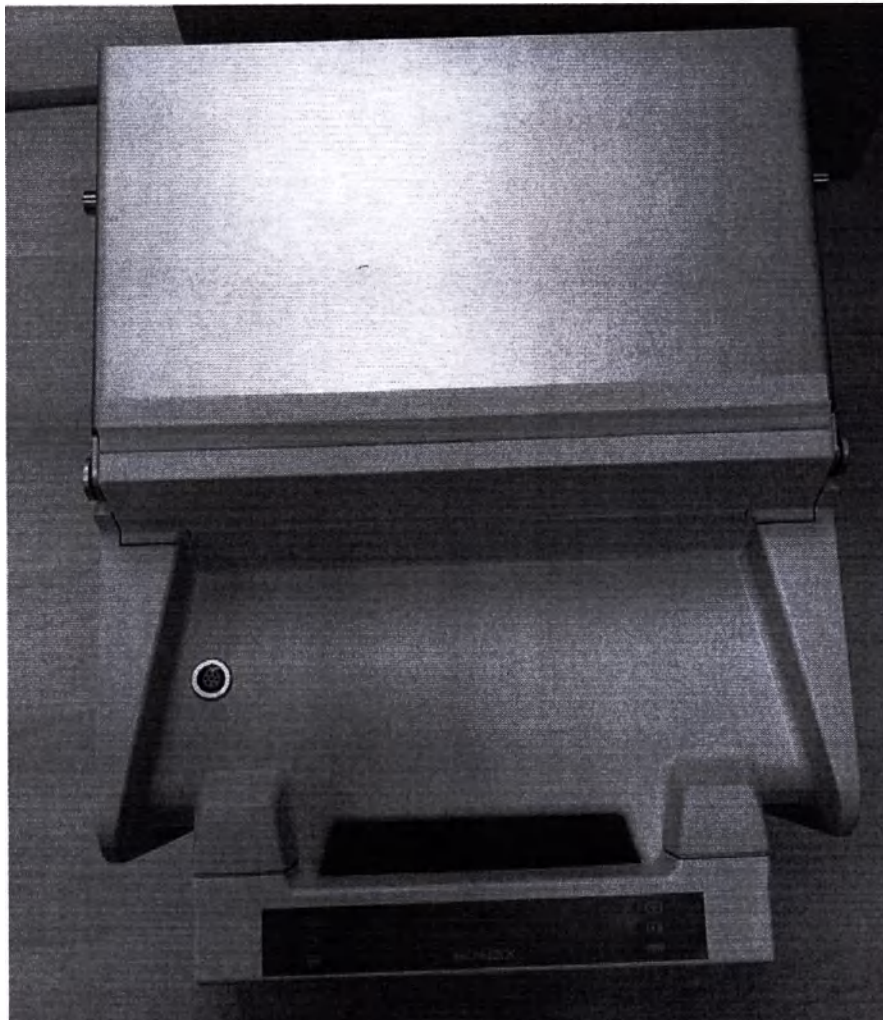


Фото 12 - Блок питания (Xenios power supply) – внешний вид образца

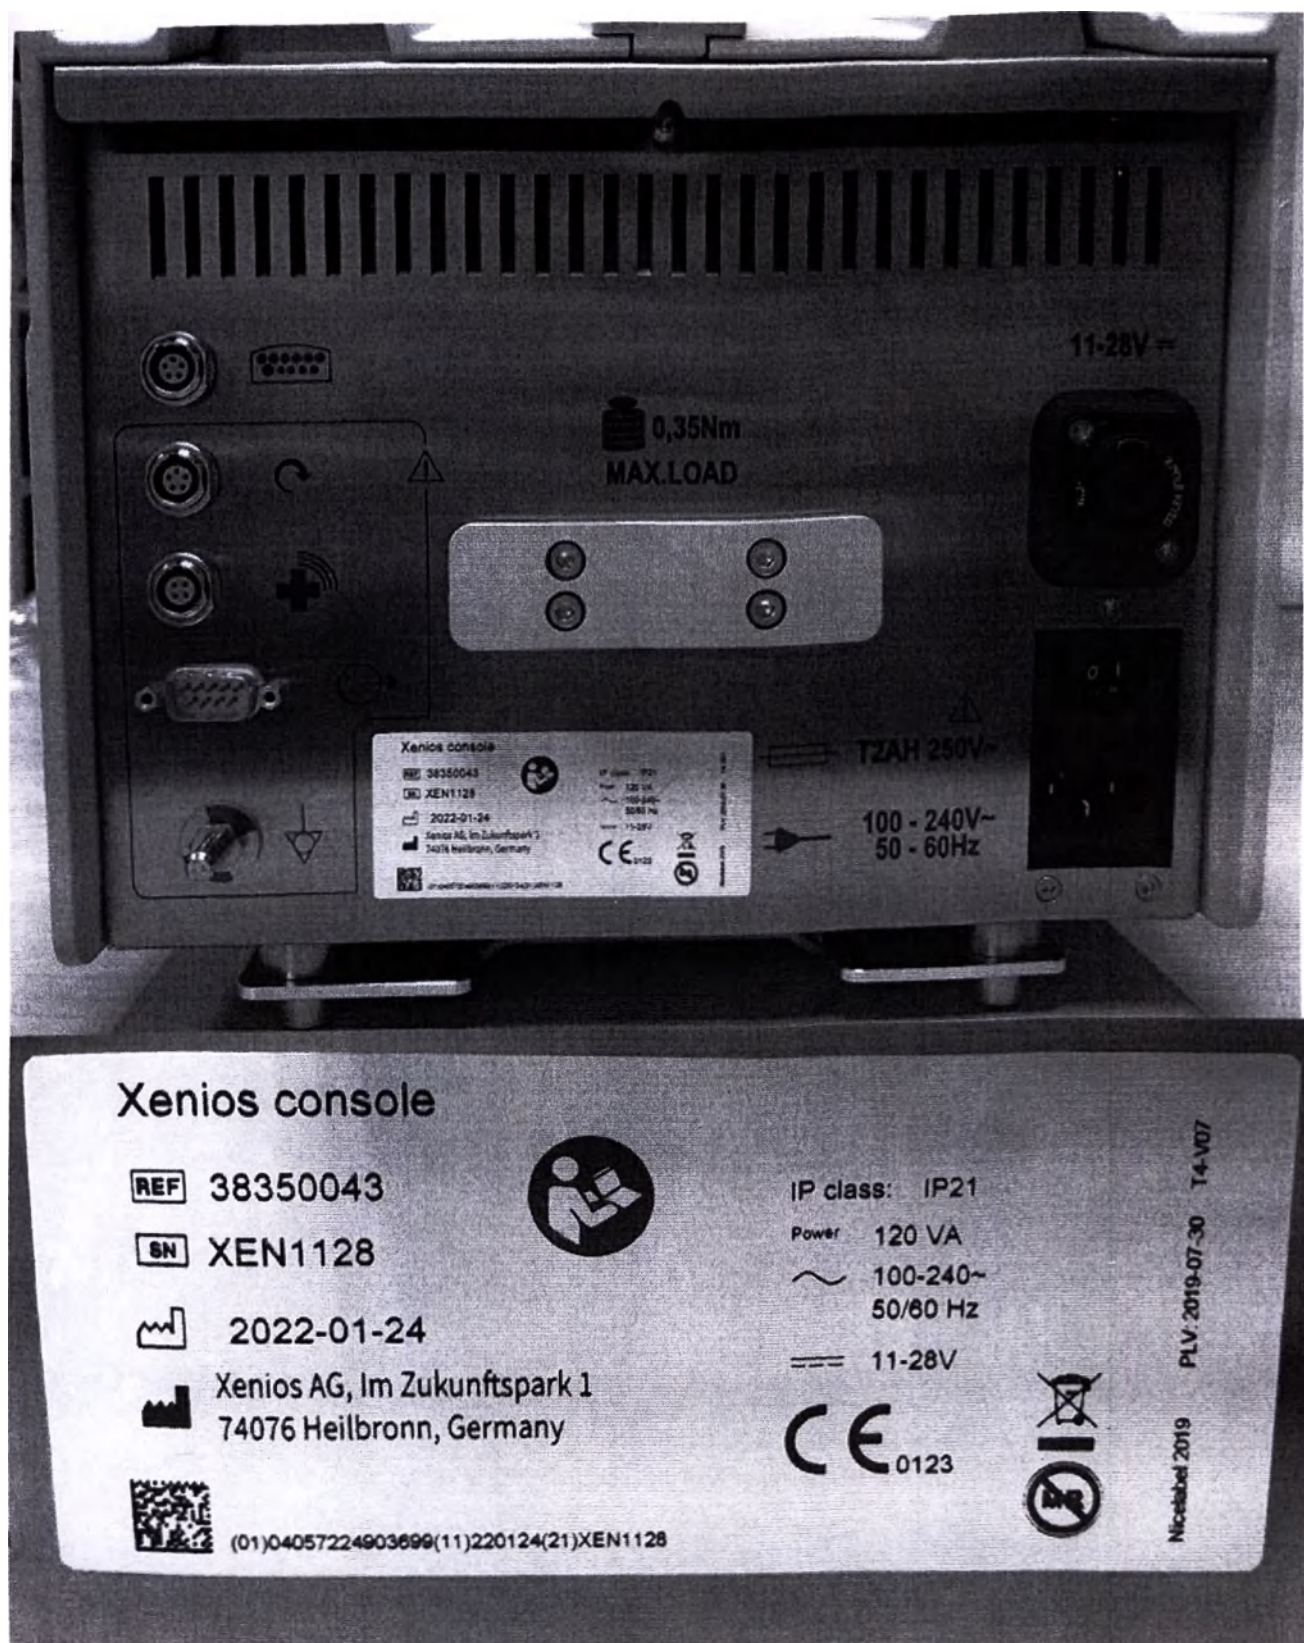


Фото 13 - Блок питания (Xenios power supply) – маркировка образца



ООО Испытательный лабораторный центр «МедТестПрибор»
Аттестат аккредитации: РОСС RU.0001.21МП26 от 22.07.2015



Фото 14 - Панель управления (Xenios control panel) – внешний вид упаковки

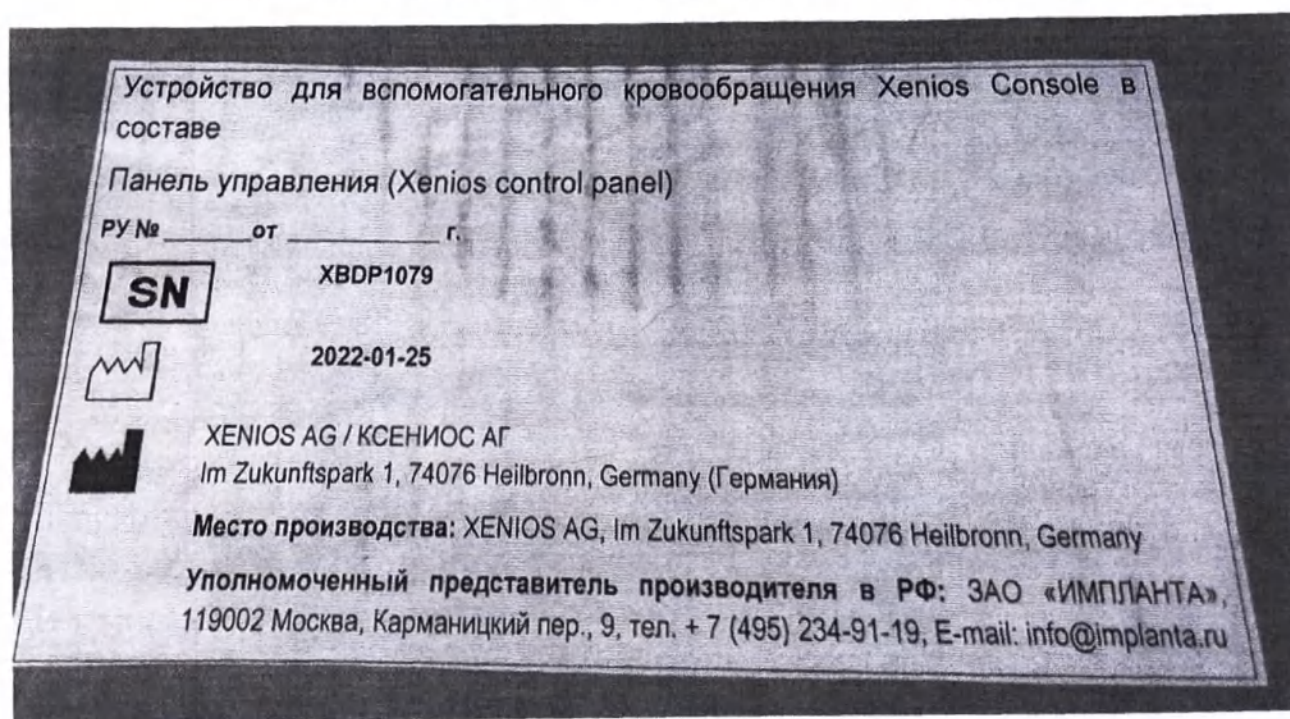


Фото 15 - Панель управления (Xenios control panel) – маркировка упаковки



Фото 16 - Панель управления (Хепиос control panel) – внешний вид образцы



ООО Испытательный лабораторный центр «МедТестПрибор»
Аттестат аккредитации: РОСС RU.0001.21МП26 от 22.07.2015



Фото 17 - Панель управления (Xenios control panel) – маркировка образца

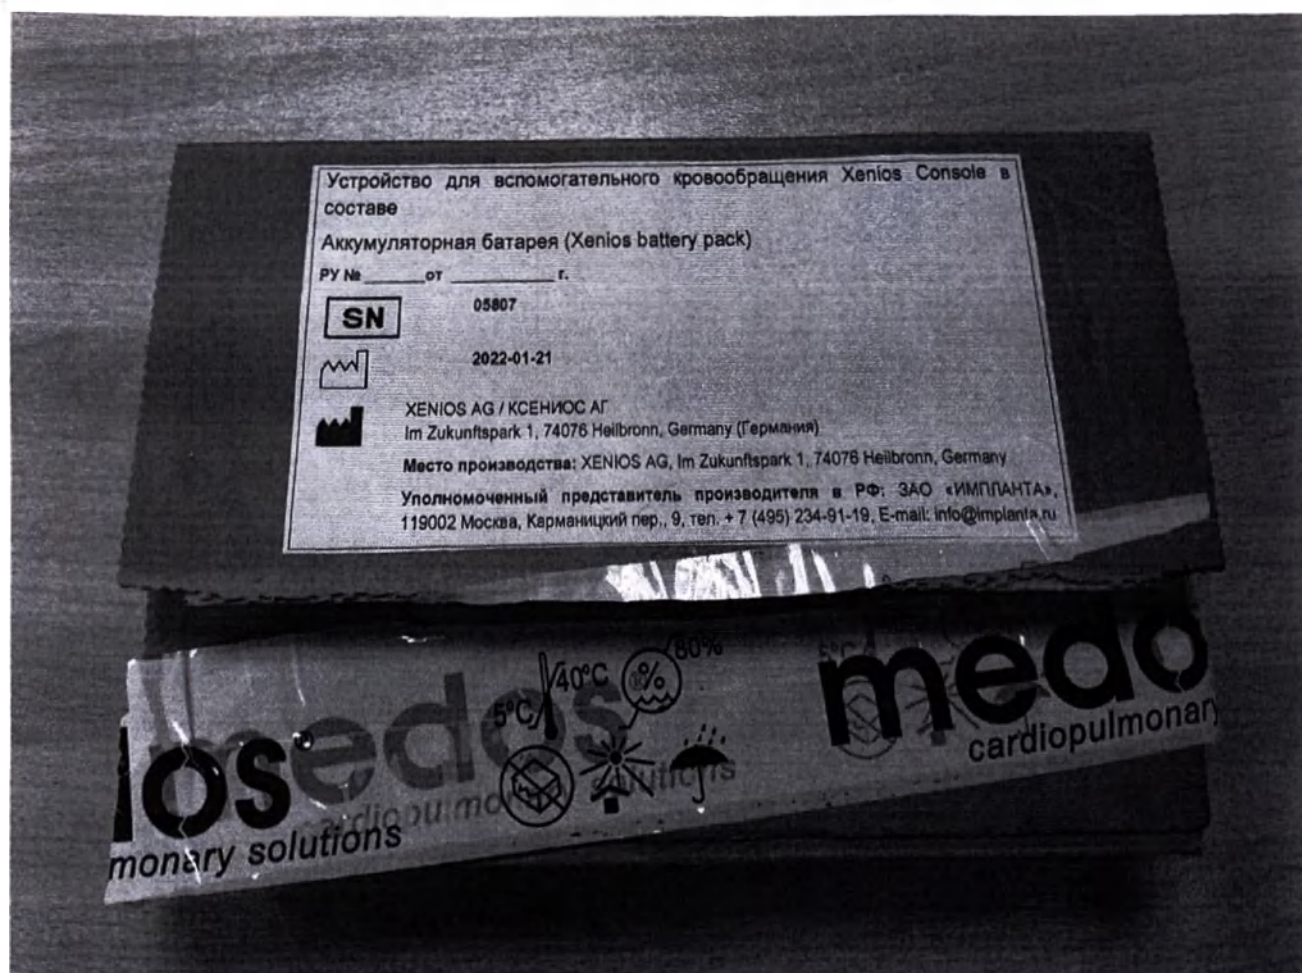


Фото 18- Аккумуляторная батарея (Xenios battery pack) – внешний вид и маркировка упаковки



Фото 19 - Аккумуляторная батарея (Xenios battery pack) – внешний вид образца



Фото 20 - Аккумуляторная батарея (Xenios battery pack) - маркировка образца

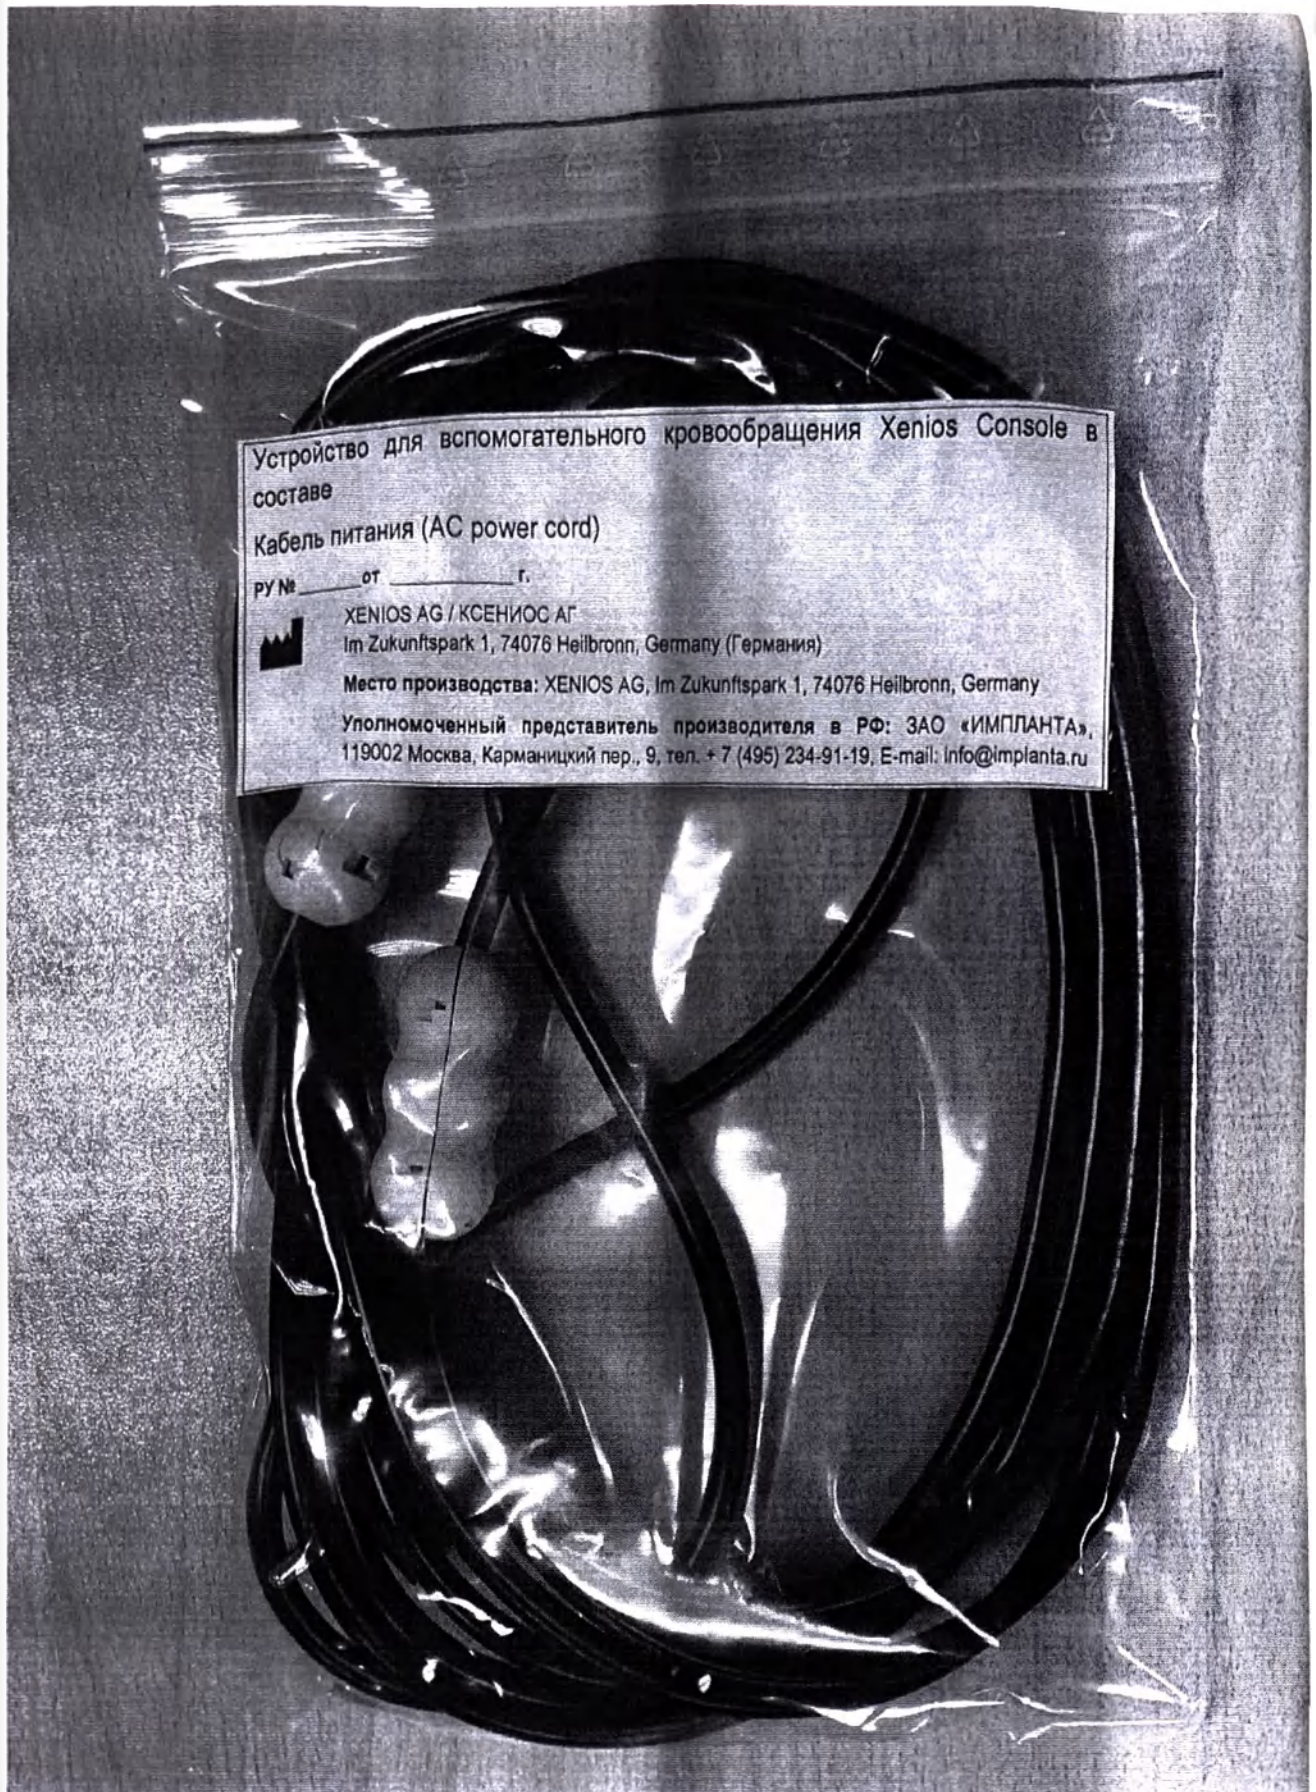


Фото 21- Кабель питания (AC power cord) - внешний вид и маркировка упаковки, внешний вид образца



ООО Испытательный лабораторный центр «МедТестПрибор»
Аттестат аккредитации: РОСС RU.0001.21МП26 от 22.07.2015




Фото 22 - Кабель выравнивания потенциалов (ZPA cable 6 mm) - внешний вид и маркировка упаковки, внешний вид образца



ООО Испытательный лабораторный центр «МедТестПрибор»
Аттестат аккредитации: РОСС RU.0001.21МП26 от 22.07.2015



Фото 23- Блок датчиков с ЭКГ (Хеніос Sensor box ECG) – внешний вид упаковки



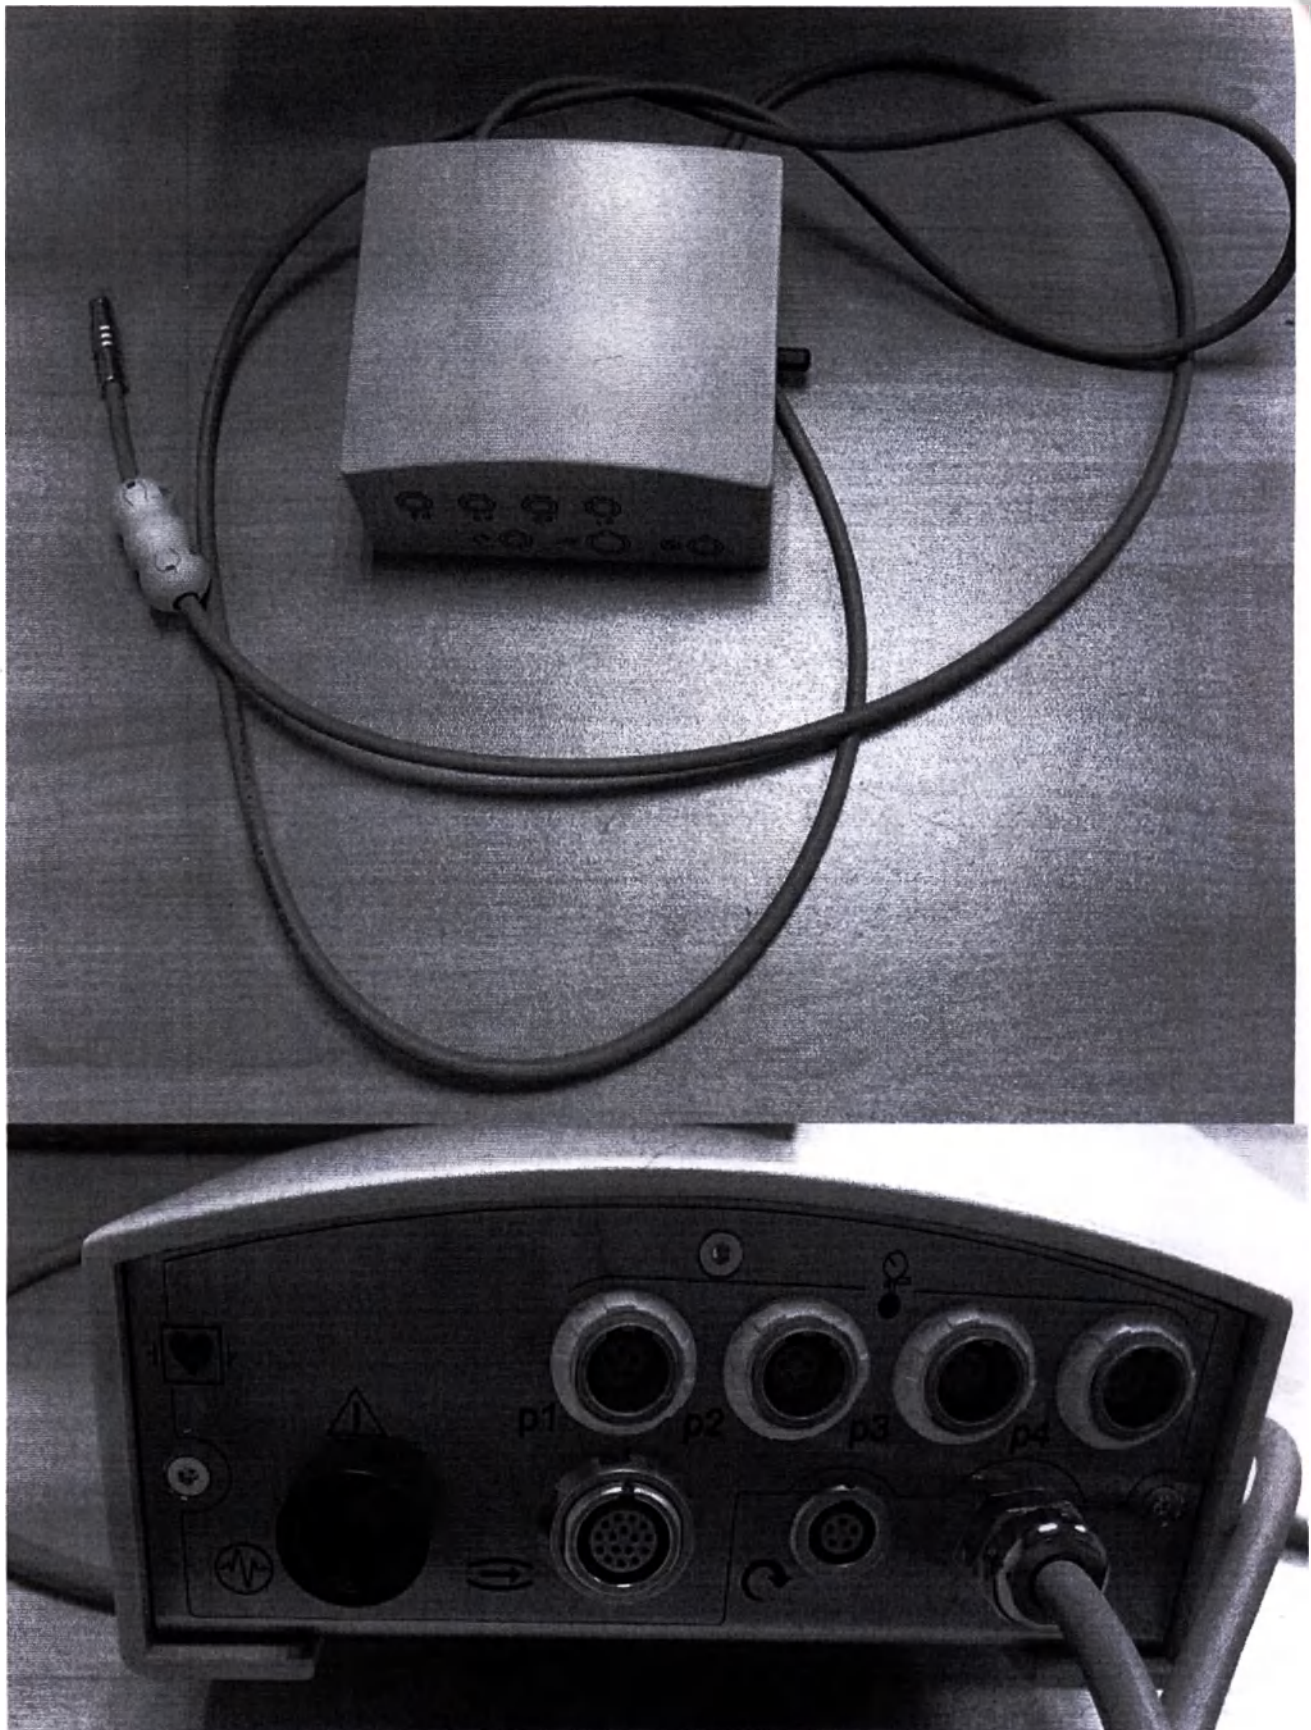


Фото 25 - Блок датчиков с ЭКГ (Xenios Sensor box ECG) – внешний вид образца

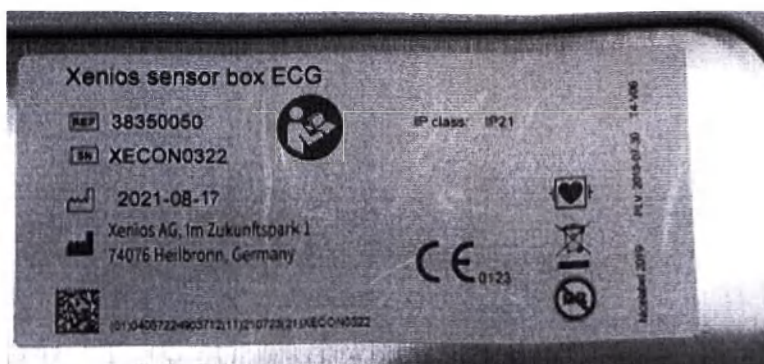


Фото 26 - Блок датчиков с ЭКГ (Xenios Sensor box ECG) – маркировка образца

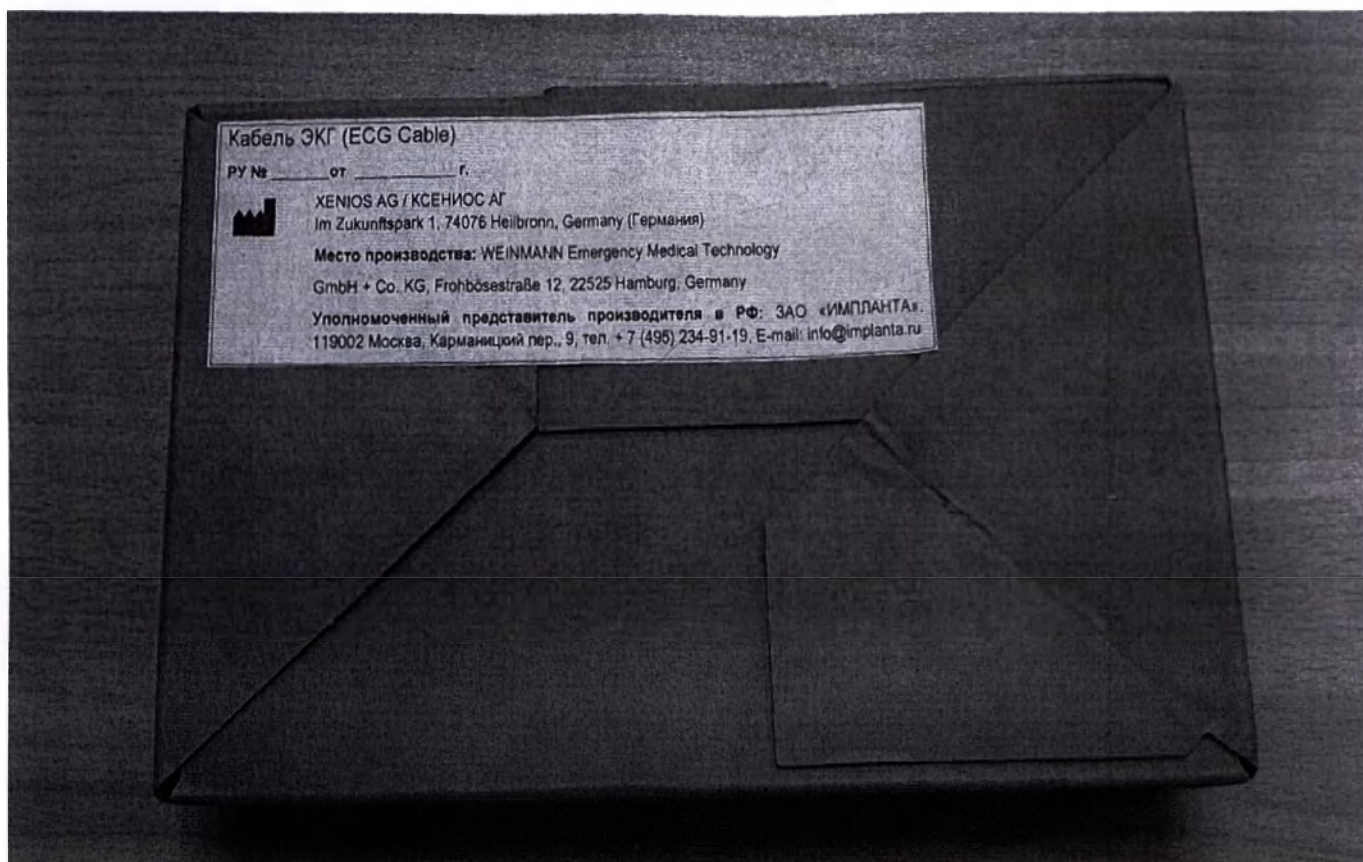


Фото 27 - Кабель ЭКГ (ECG Cable) – внешний вид и маркировка упаковки

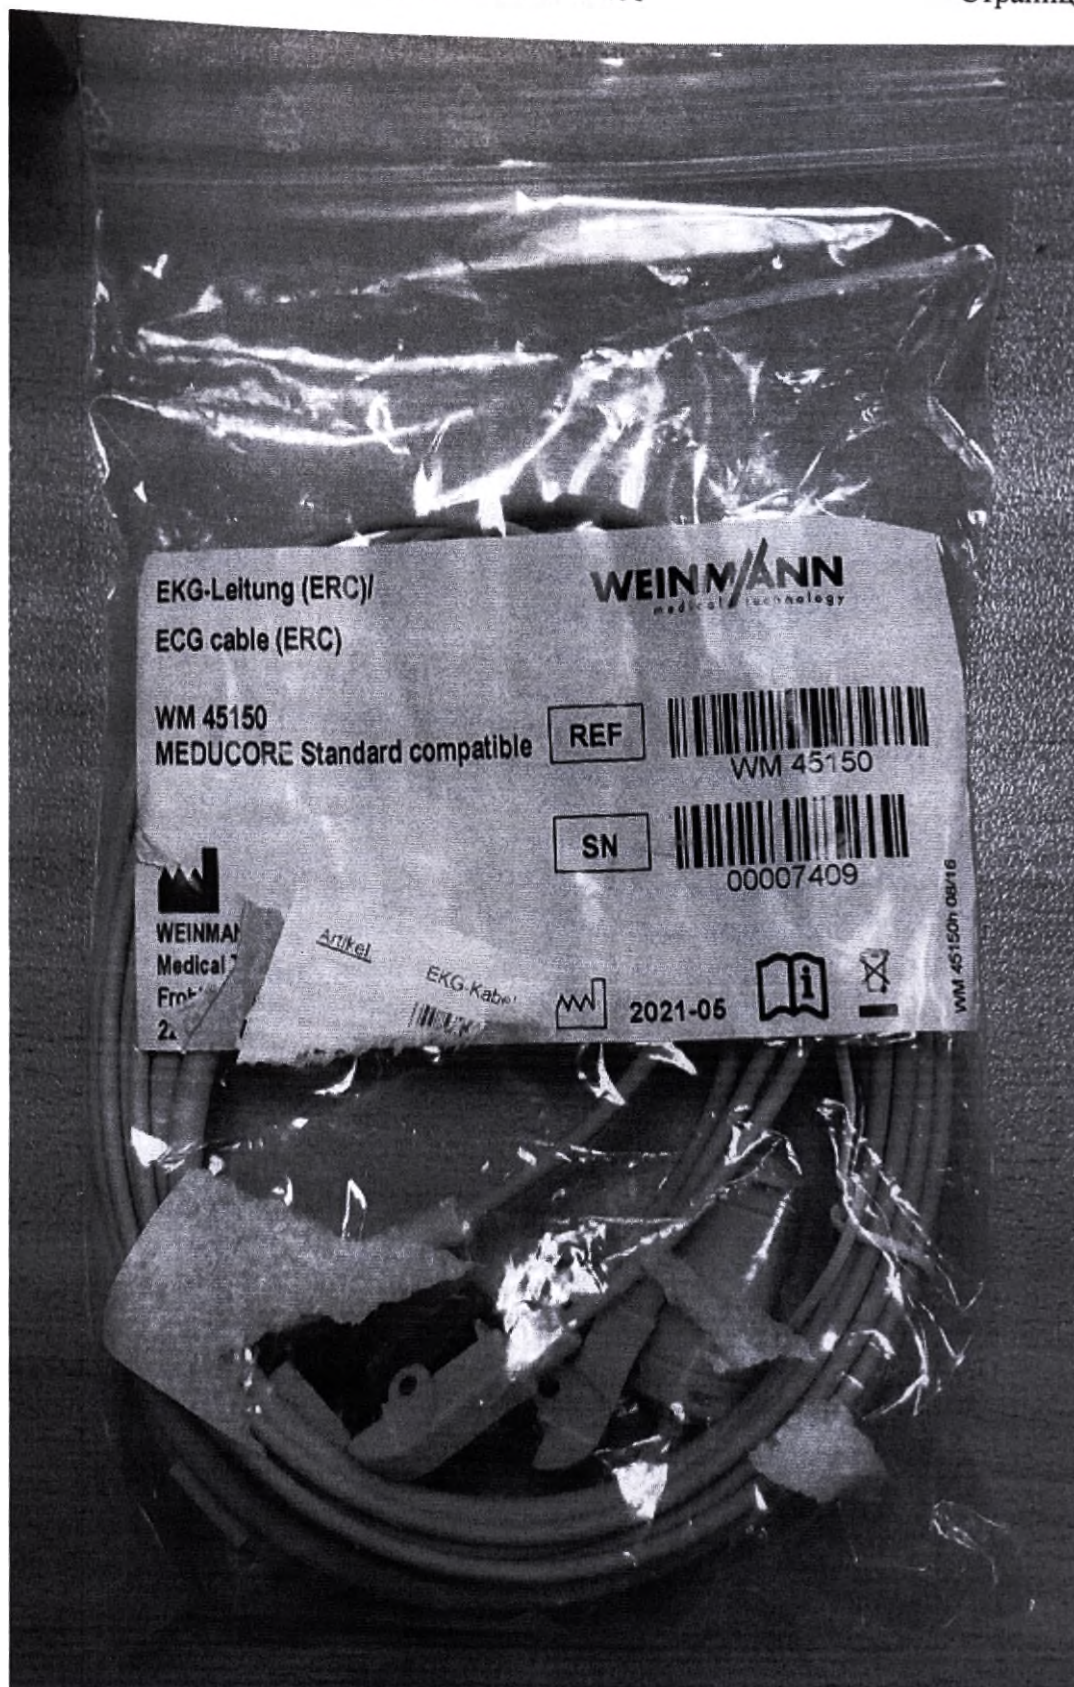


Фото 28 - Кабель ЭКГ (ECG Cable) – внешний вид и маркировка упаковки

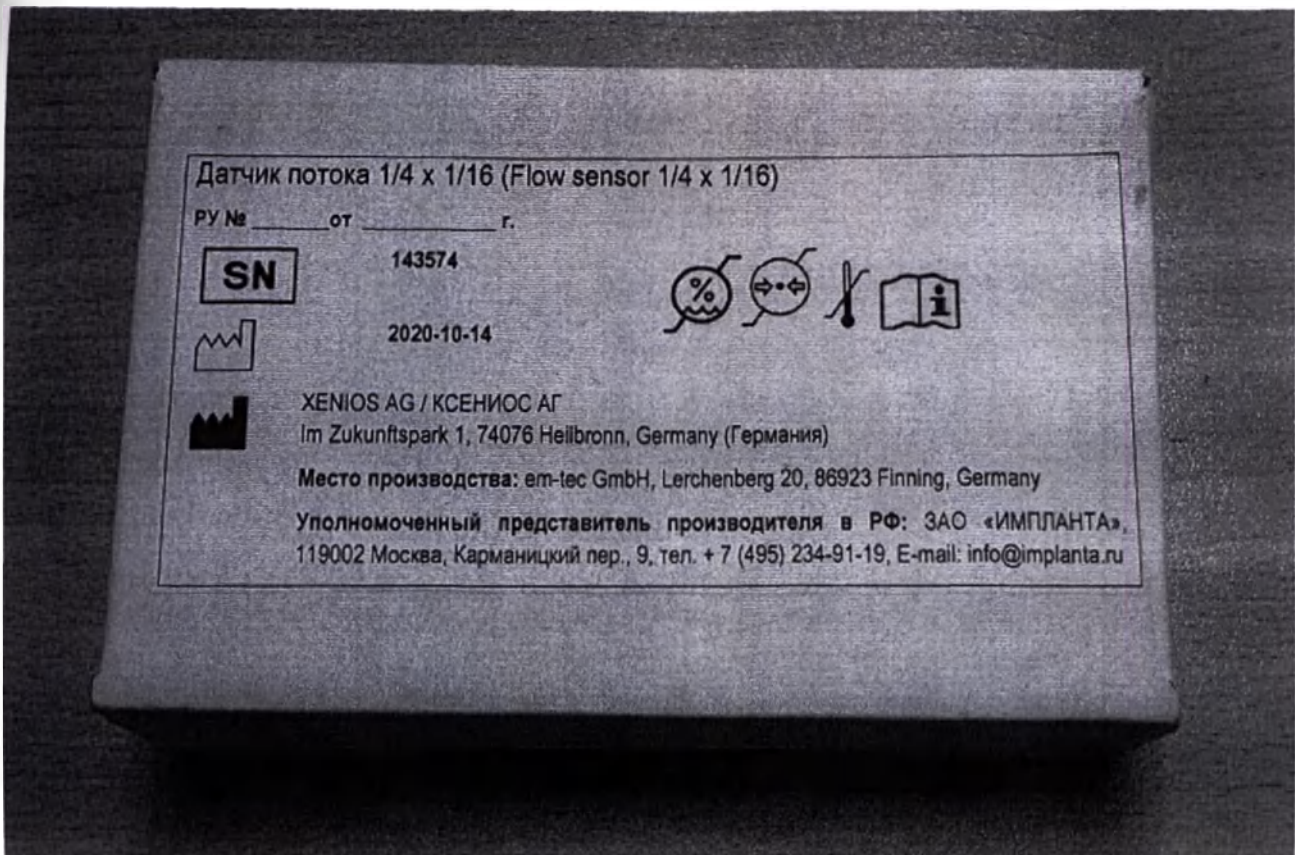


Фото 32 - Датчик потока 1/4 x 1/16 (Flow sensor 1/4 x 1/16) – внешний вид и маркировка упаковки



Фото 33- Датчик потока 1/4 x 1/16 (Flow sensor 1/4 x 1/16) – внешний вид образца

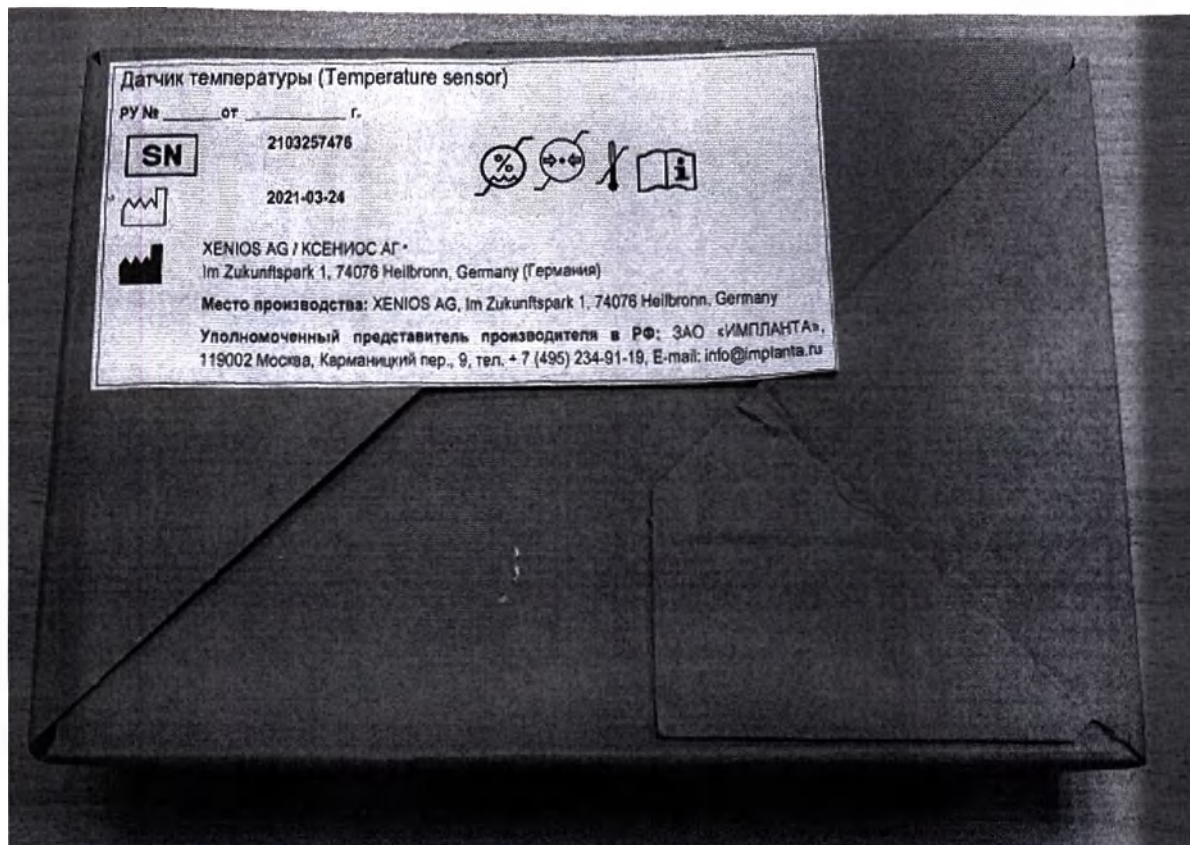


Фото 34- Датчик температуры (Temperature sensor) – внешний вид и маркировка упаковки


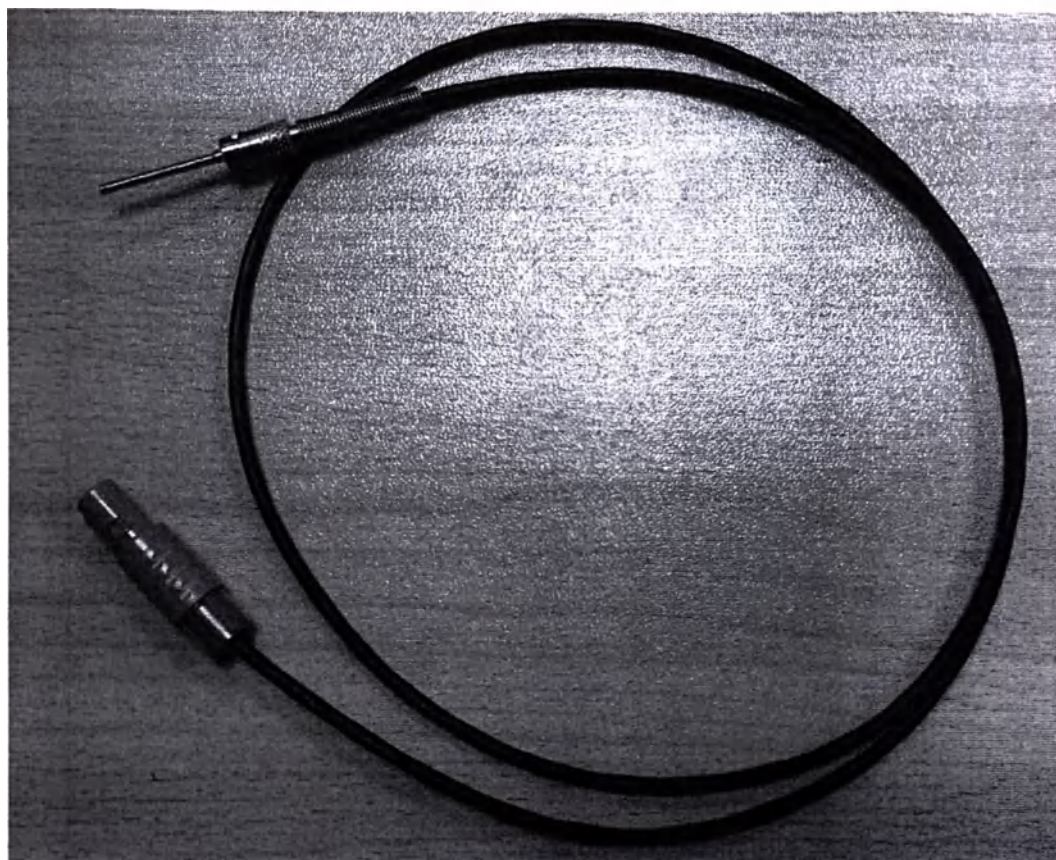


Фото 35 - Датчик температуры (Temperature sensor) – внешний вид образца



ООО Испытательный лабораторный центр «МедТестПрибор»
Аттестат аккредитации: РОСС RU.0001.21МП26 от 22.07.2015

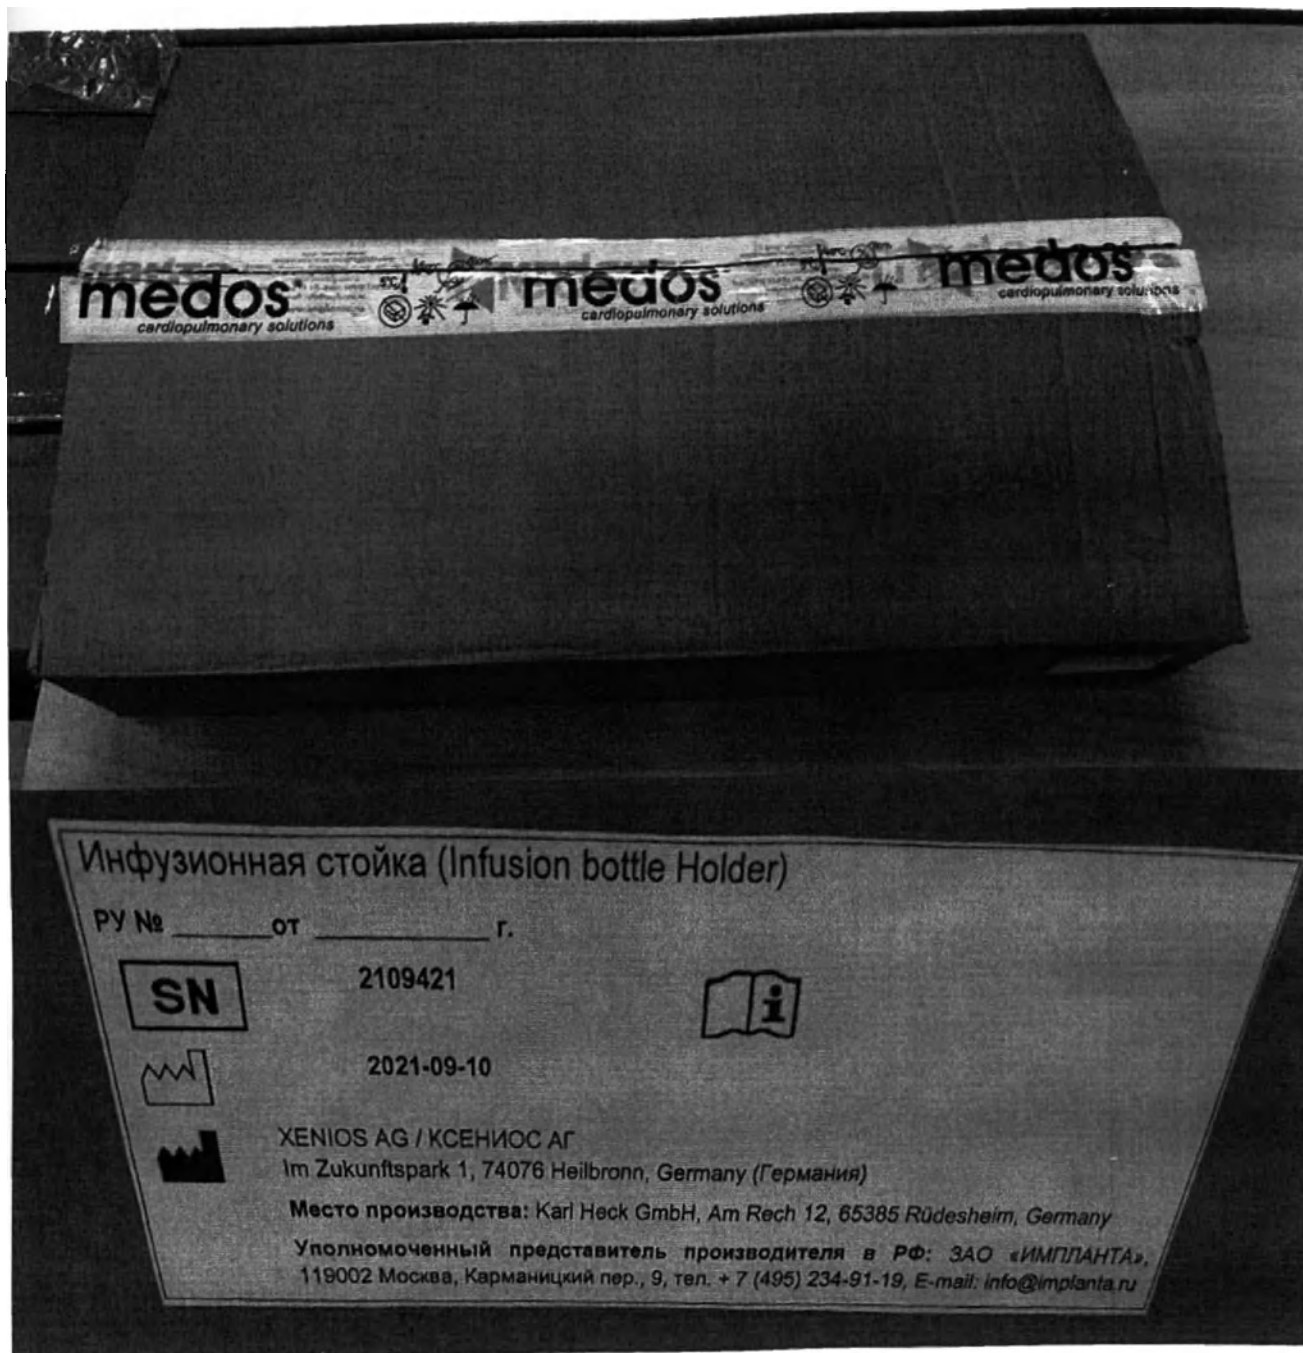


Фото 36 - Инфузионная стойка (Infusion bottle Holder) – внешний вид и маркировка упаковки



ООО Испытательный лабораторный центр «МедТестПрибор»
Аттестат аккредитации: РОСС RU.0001.21МП26 от 22.07.2015



Фото 37 - Инфузионная стойка (Infusion bottle Holder) – внешний вид и маркировка образца



ООО Испытательный лабораторный центр «МедТестПрибор»
Аттестат аккредитации: РОСС RU.0001.21МП26 от 22.07.2015

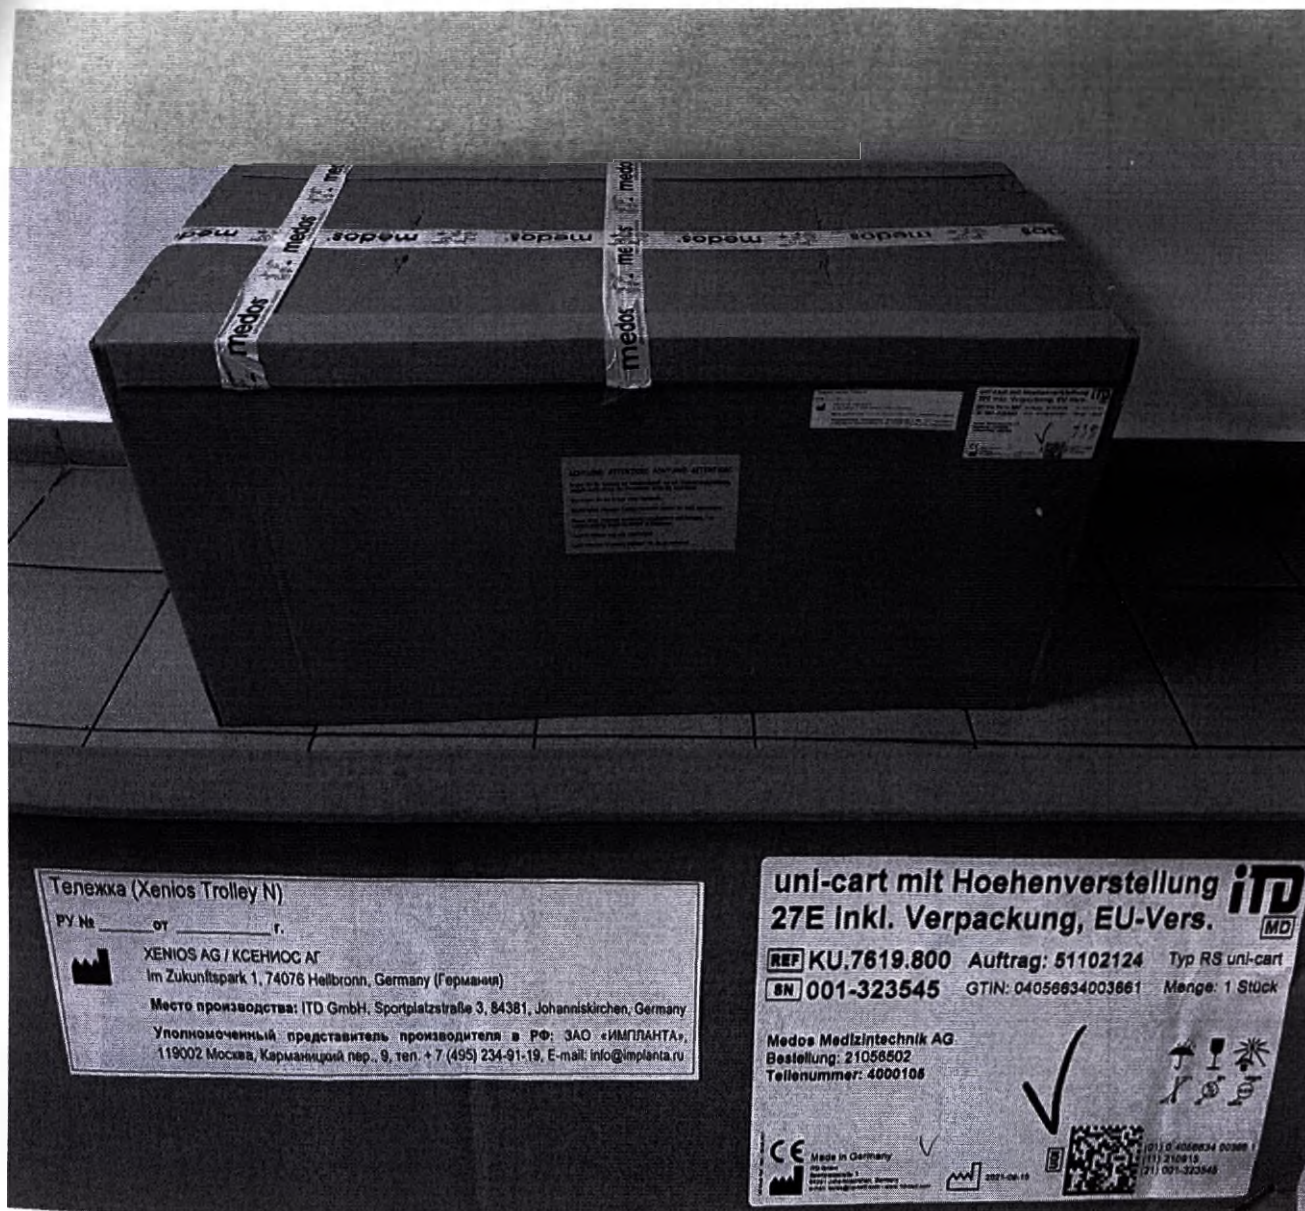


Фото 38- Тележка (Xenios Trolley N) – внешний вид упаковки

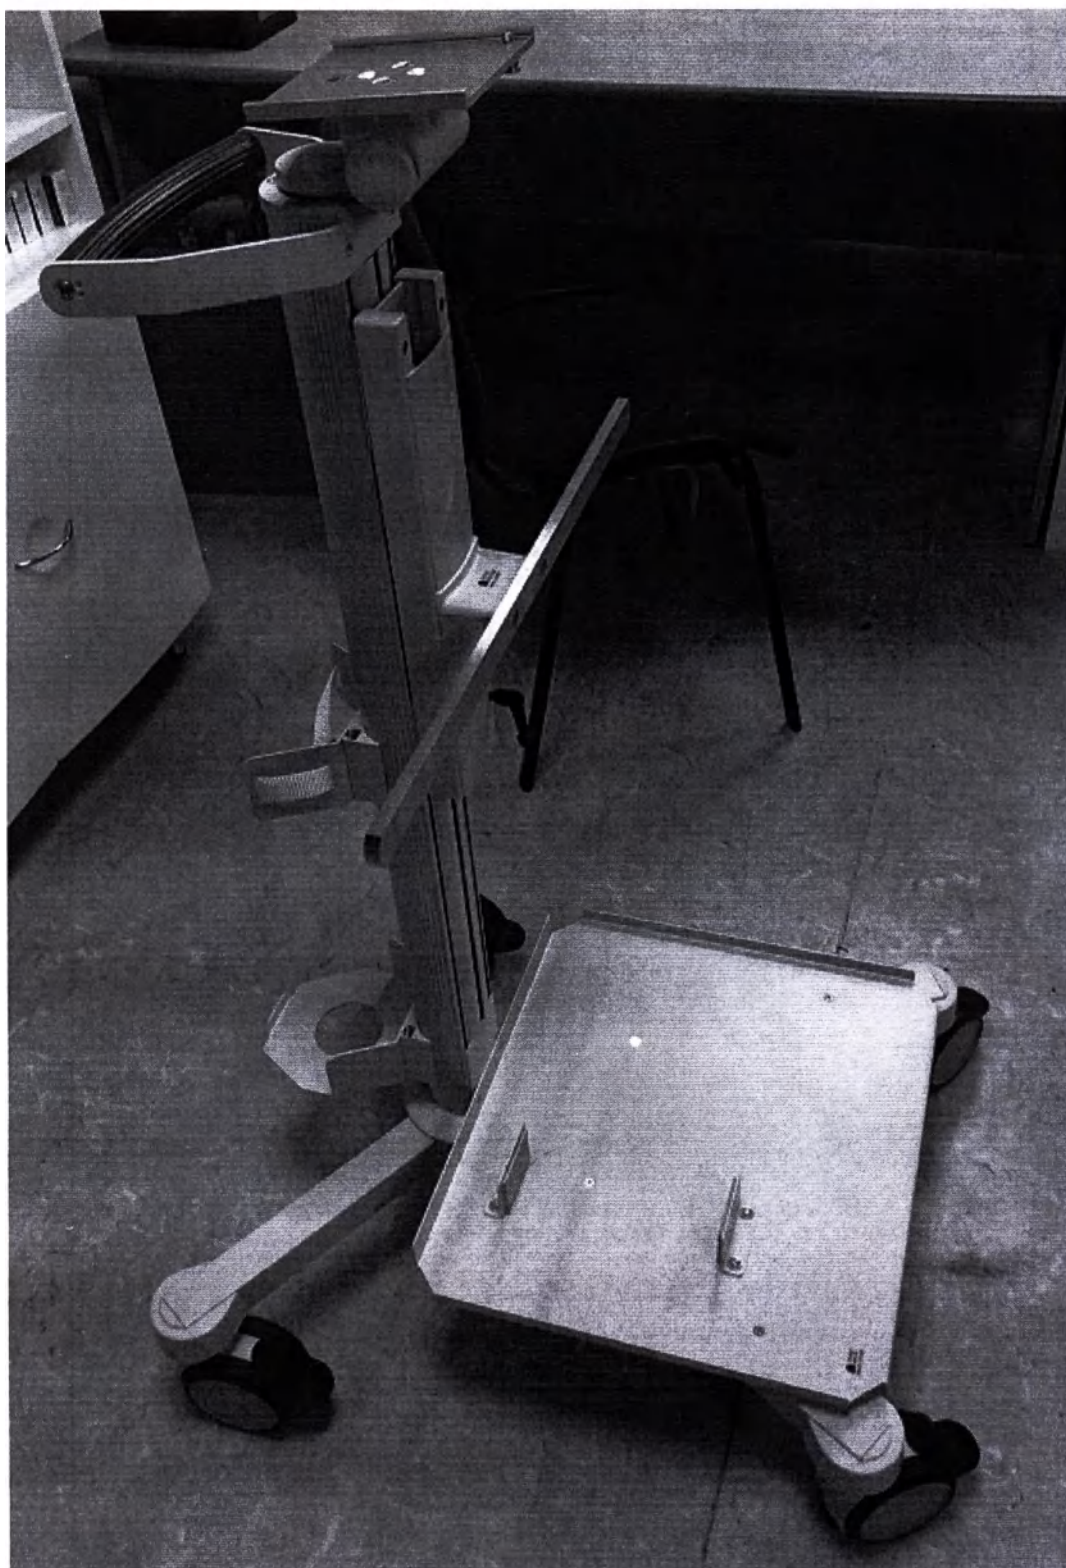


Фото 39- Тележка (Хеніос Trolley N) – внешний вид образца



ООО Испытательный лабораторный центр «МедТестПрибор»
Аттестат аккредитации: РОСС RU.0001.21МП26 от 22.07.2015

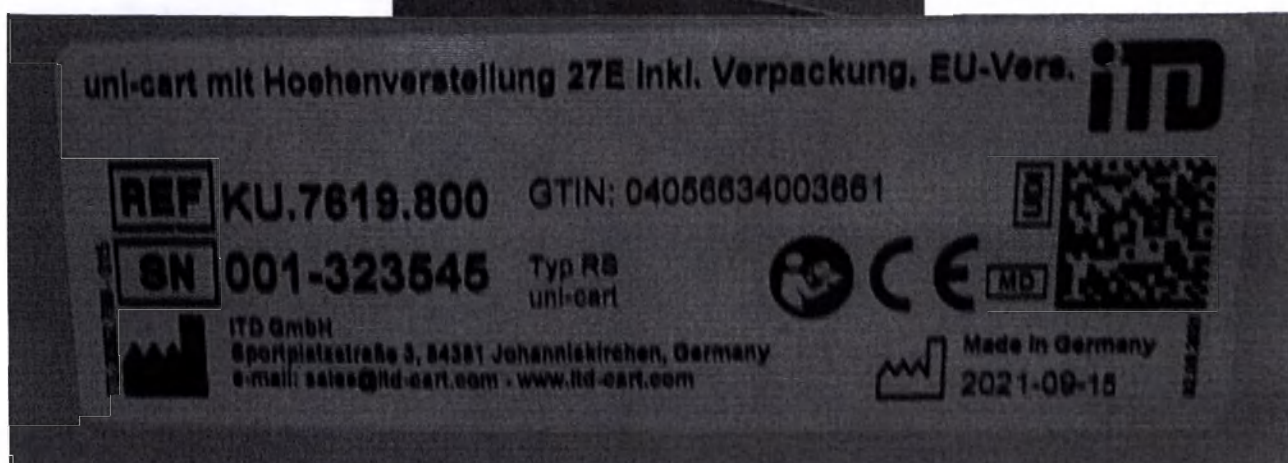
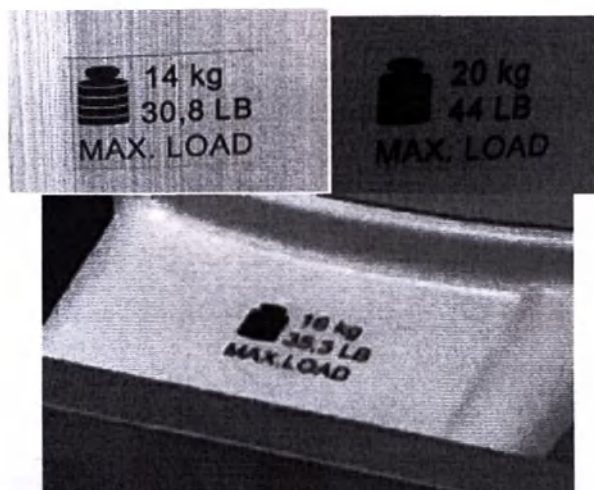


Фото 40 - Тележка (Xenios Trolley N) – маркировка образца

Принадлежности:

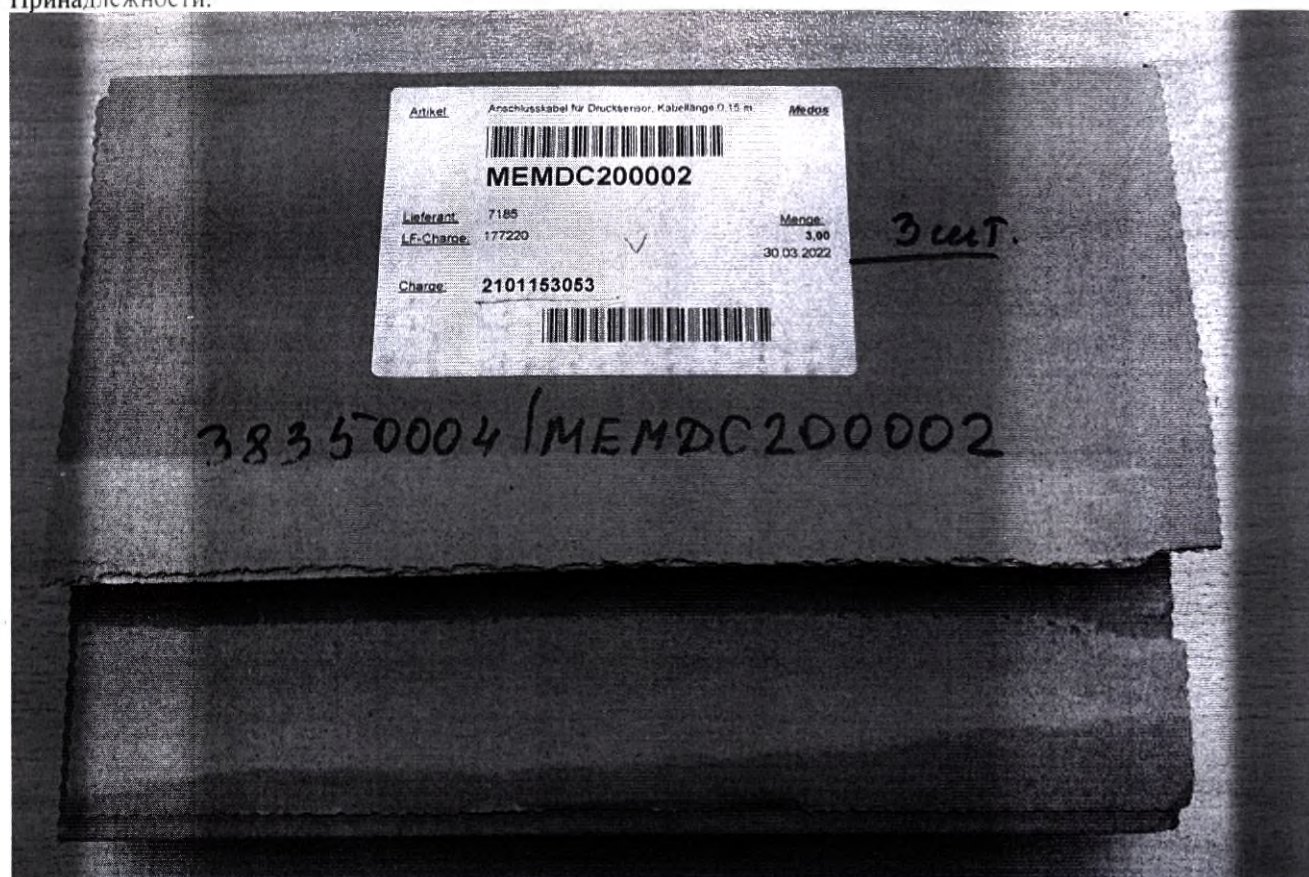


Фото 41- Кабель датчика давления (Pressure sensor connecting cable PVB) – внешний вид упаковки

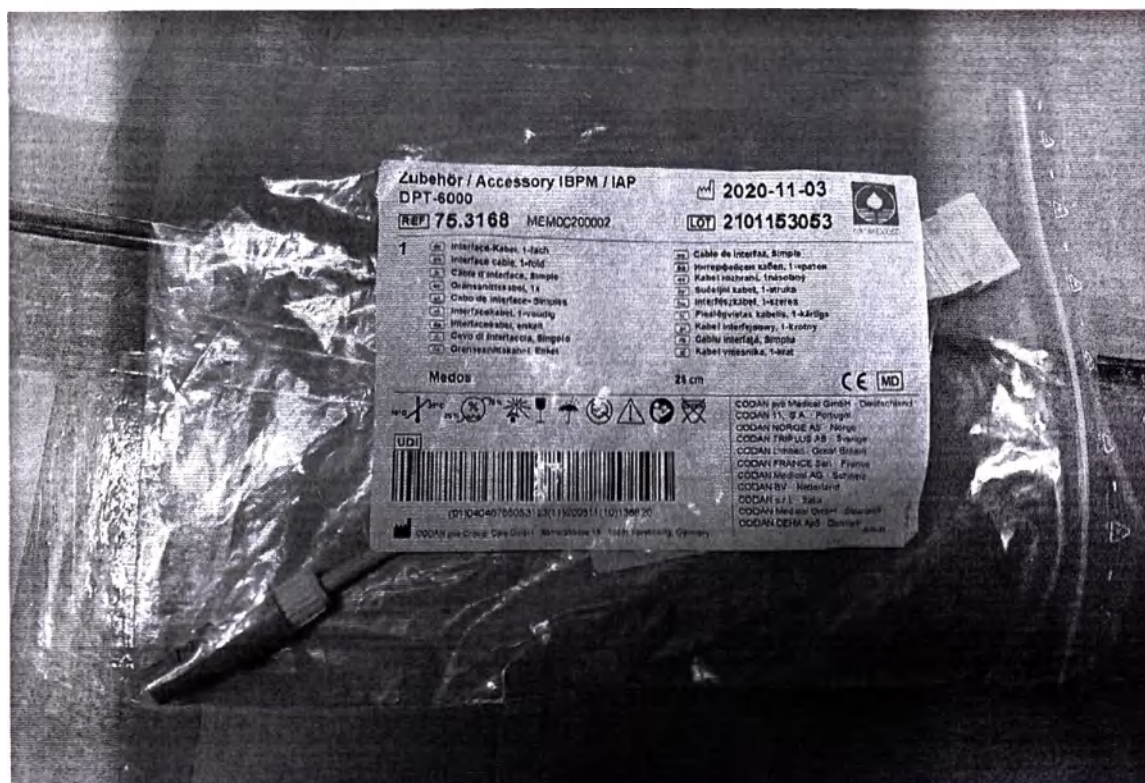


Фото 42 - Кабель датчика давления (Pressure sensor connecting cable PVB) – маркировка упаковки



ООО Испытательный лабораторный центр «МедТестПрибор»
Аттестат аккредитации: РОСС RU.0001.21МП126 от 22.07.2015



Фото 43 - Кабель датчика давления (Pressure sensor connecting cable PVB) – внешний вид образца

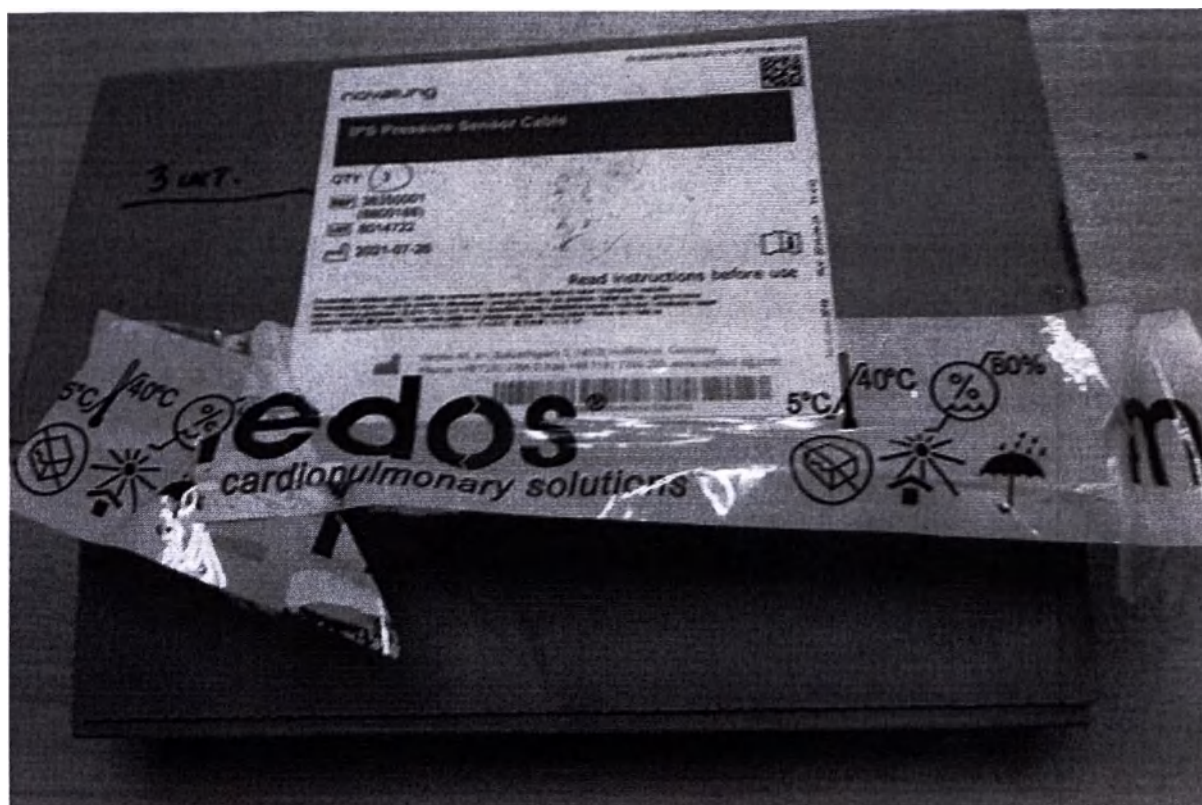


Фото 44 - Кабель встроенного датчика давления (IPS pressure sensor cable) – внешний вид упаковки



Фото 45 - Кабель встроенного датчика давления (IPS pressure sensor cable) – внешний вид упаковки

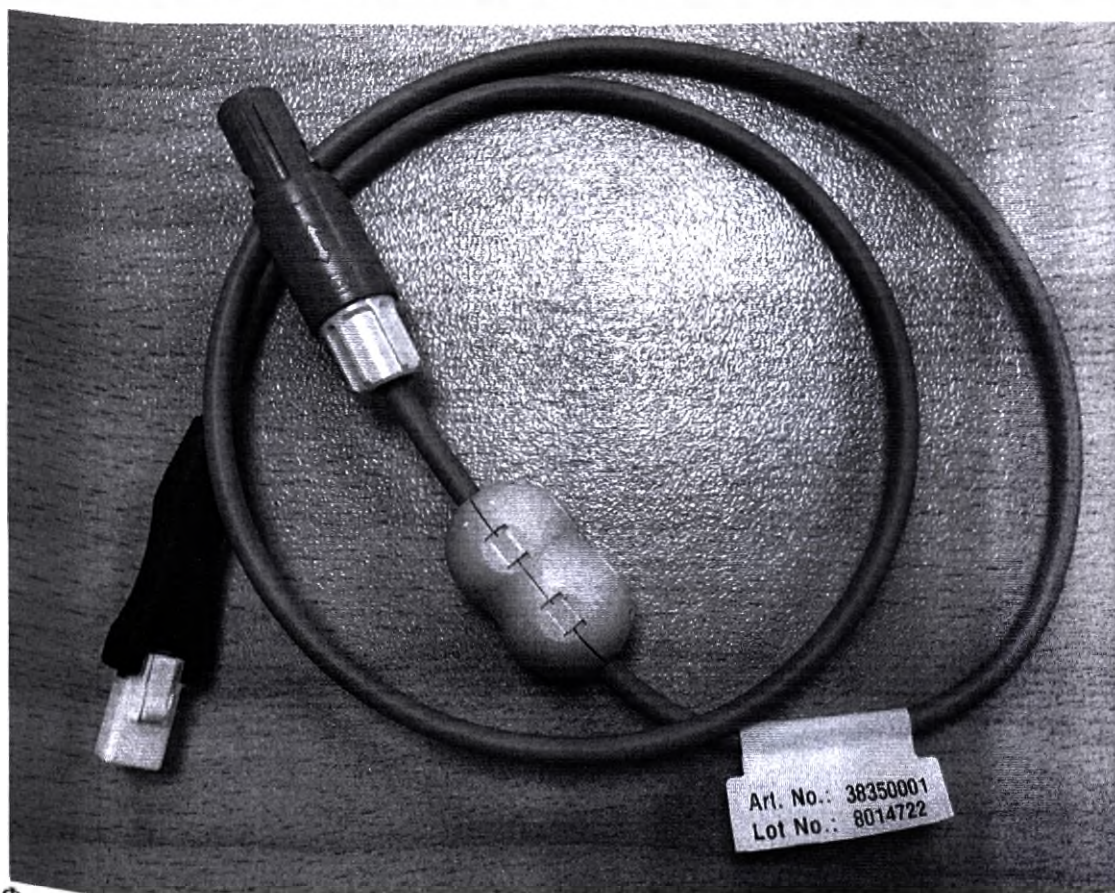


Фото 46 - Кабель встроенного датчика давления (IPS pressure sensor cable) – внешний вид образца

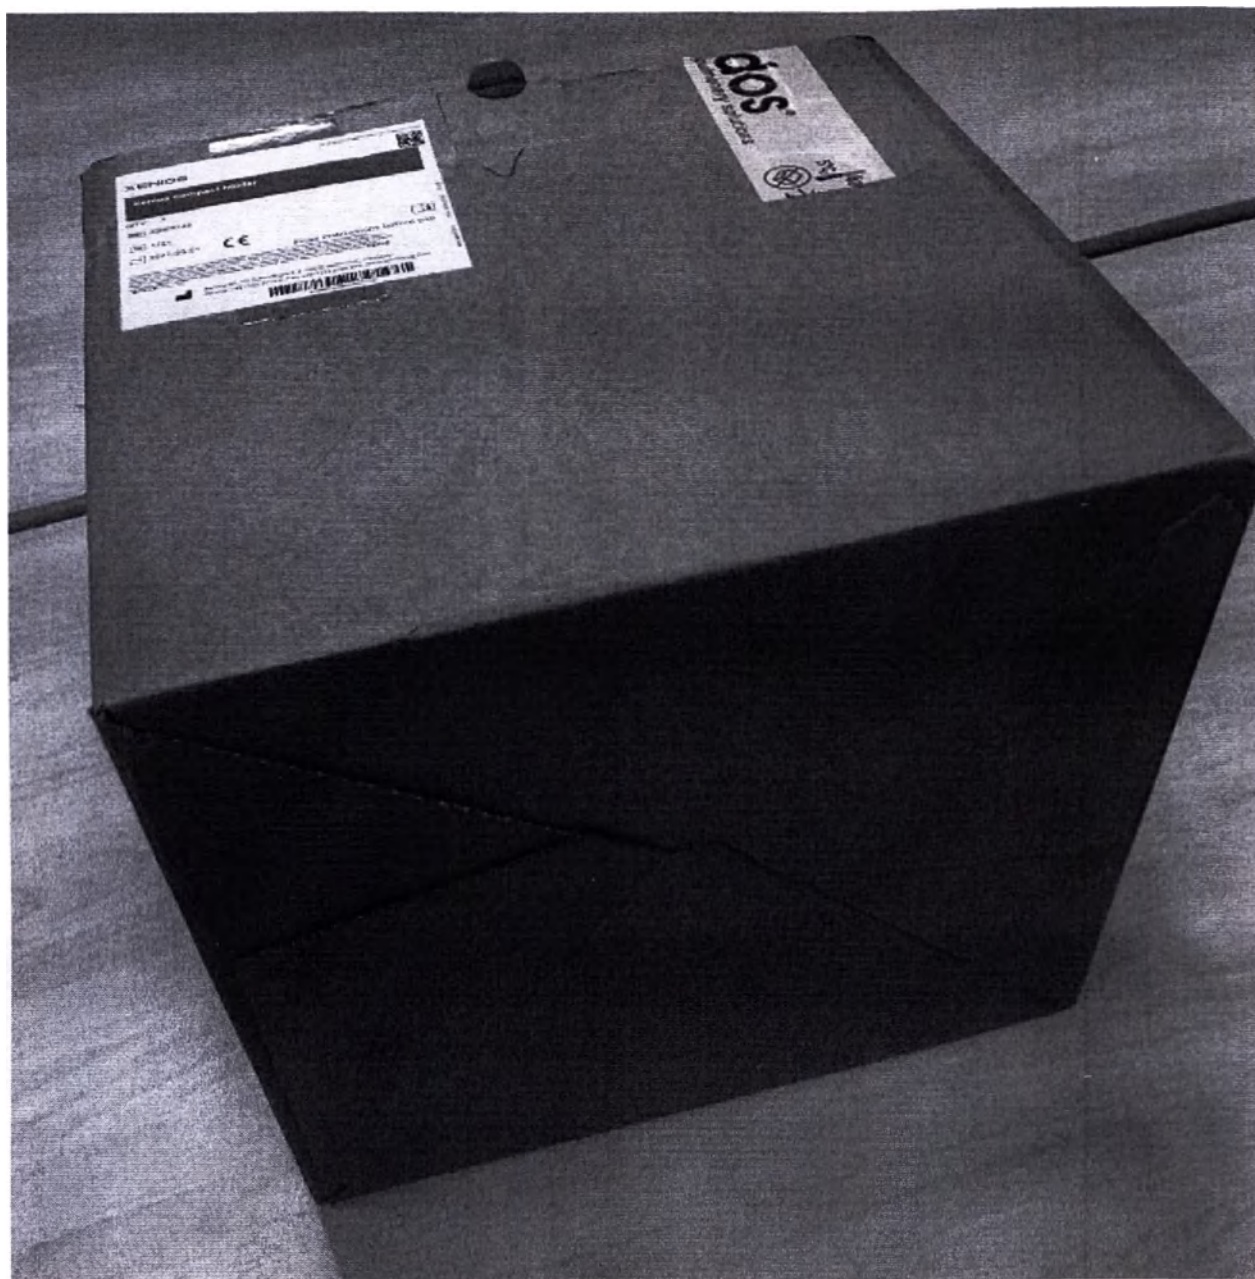


Фото 47 - Компактный держатель (Xenios compact holder) – внешний вид упаковки



ООО Испытательный лабораторный центр «МедТестПрибор»
Аттестат аккредитации: РОСС RU.0001.21МП26 от 22.07.2015


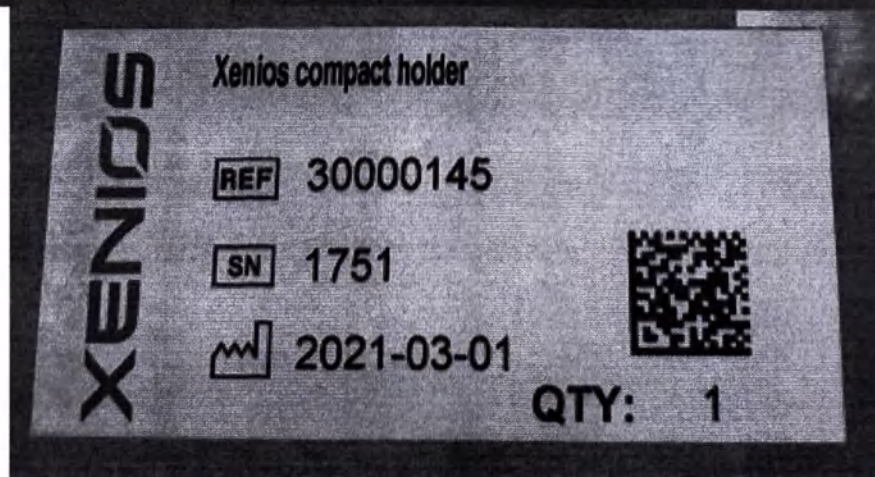


Фото 48- Компактный держатель (Xenios compact holder) – маркировка упаковки



Фото 29 - Кабель ЭКГ (ECG Cable) – внешний вид образца

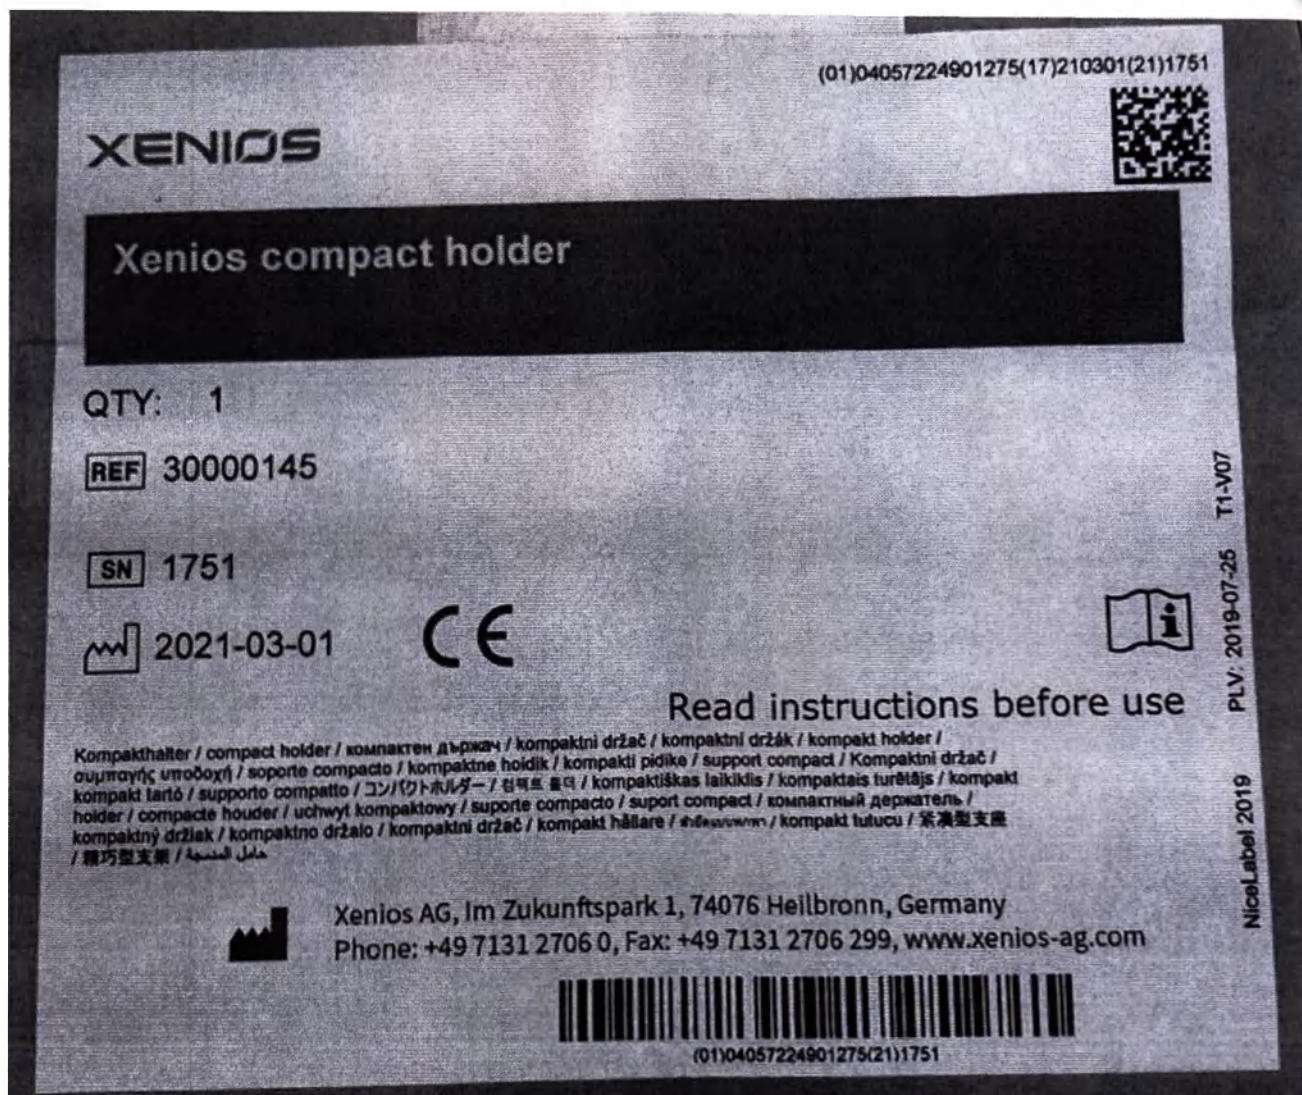

ООО Испытательный лабораторный центр «МедТестПрибор»
Аттестат аккредитации: РОСС RU.0001.21МП26 от 22.07.2015

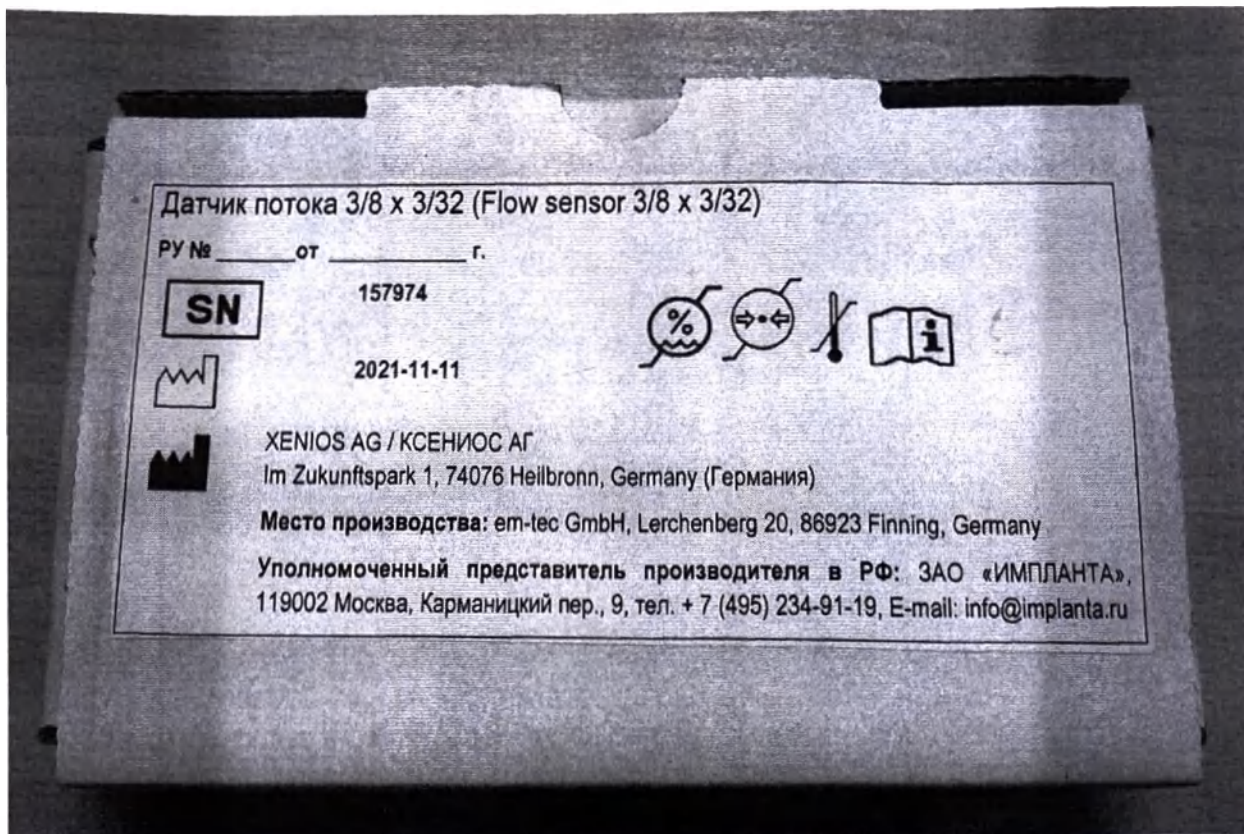


Фото 30 - Датчик потока 3/8 x 3/32 (Flow sensor 3/8 x 3/32) – внешний вид и маркировка упаковки



Фото 31 – Датчик потока 3/8 x 3/32 (Flow sensor 3/8 x 3/32) – внешний вид образца



ООО Испытательный лабораторный центр «МедТестПрибор»
Аттестат аккредитации: РОСС RU.0001.21МП26 от 22.07.2015

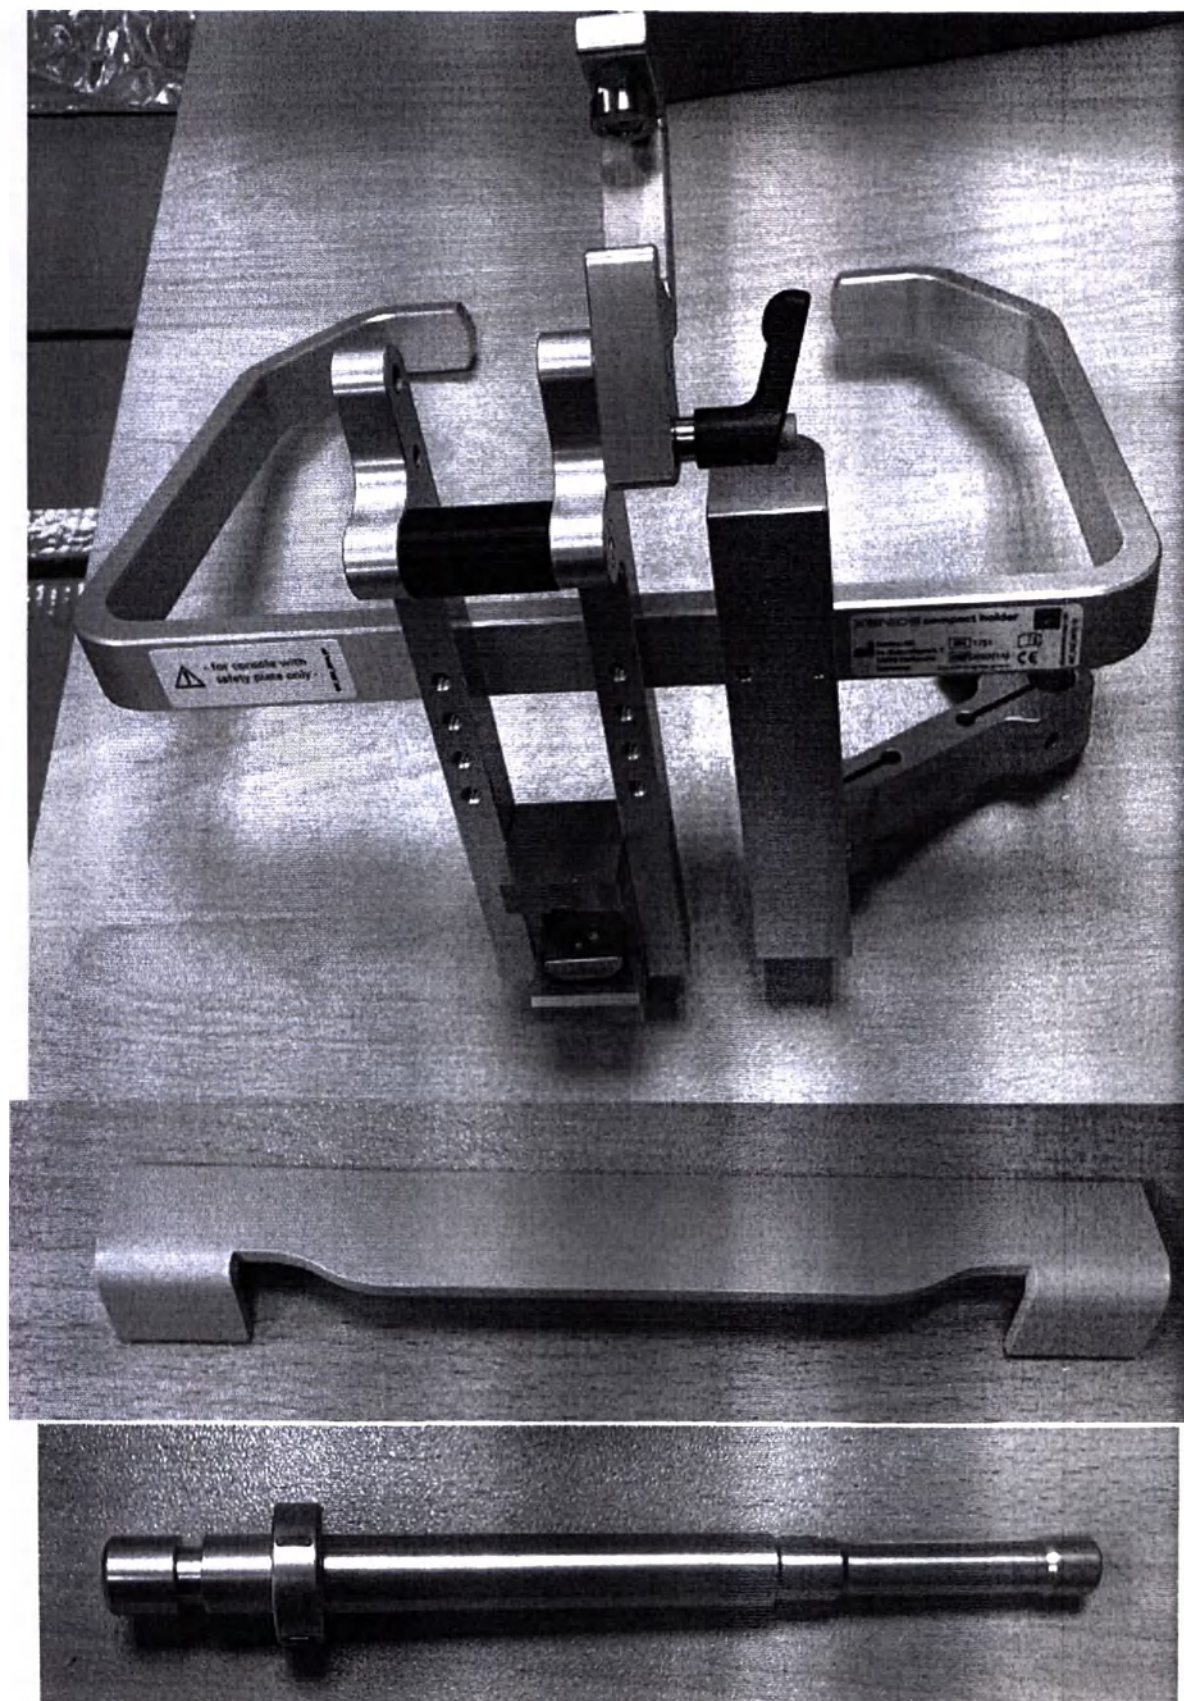


Фото 49 - Компактный держатель (Xenios compact holder) – внешний вид образца



Фото 50 - Компактный держатель (Xenios compact holder) – маркировка образца



Фото 51 - Держатель привода резервного насоса (Holder for backup pump drive) – внешний вид упаковки



ООО Испытательный лабораторный центр «МедТестПрибор»
Аттестат аккредитации: РОСС RU.0001.21МП26 от 22.07.2015



Фото 52- Держатель привода резервного насоса (Holder for backup pump drive) – маркировка упаковки

370

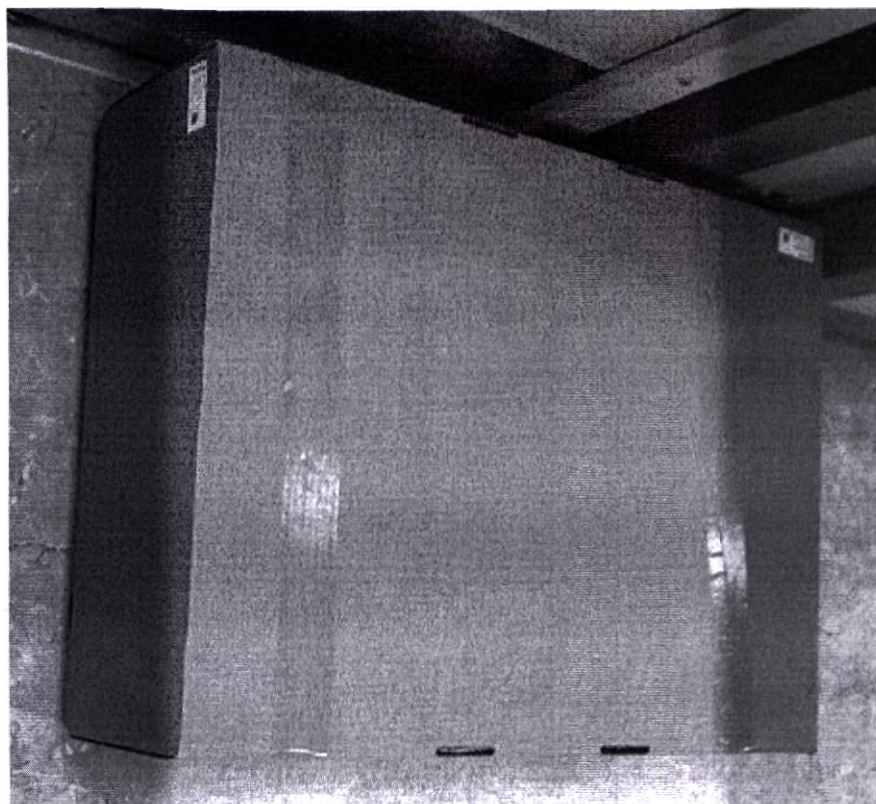


Фото 57 - Опорная площадка MSG (MSG Base Plate) – внешний вид упаковки

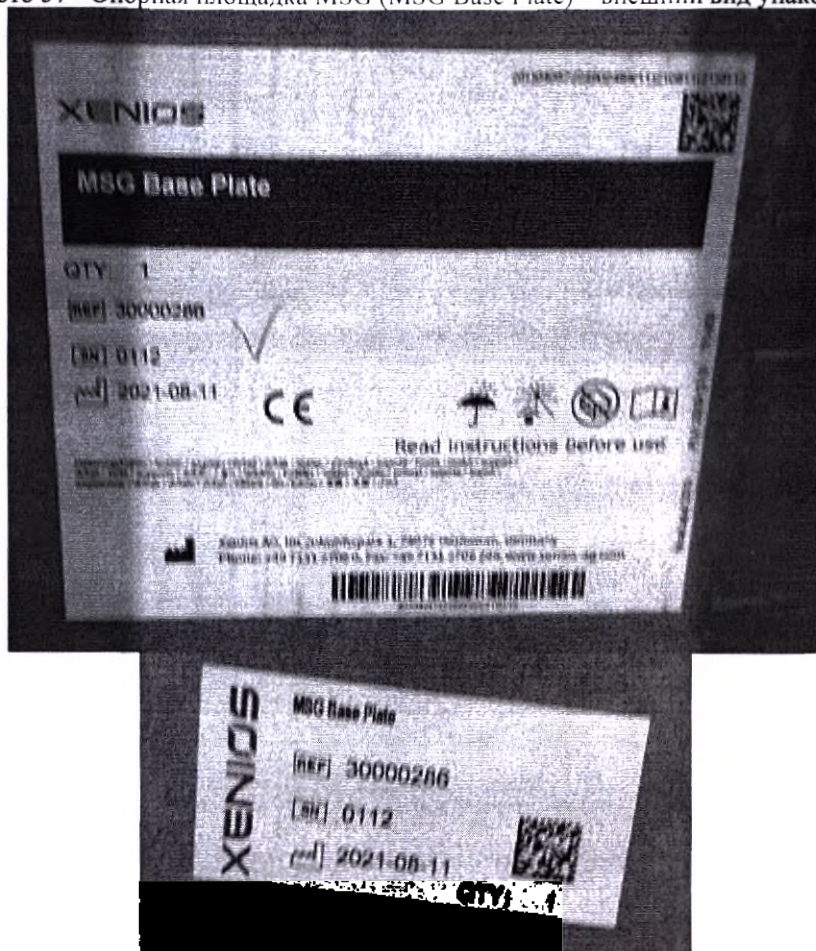


Фото 58 - Опорная площадка MSG (MSG Base Plate) – маркировка упаковки



ООО Испытательный лабораторный центр «МедТестПрибор»
Аттестат аккредитации: РОСС RU.0001.21МП26 от 22.07.2015

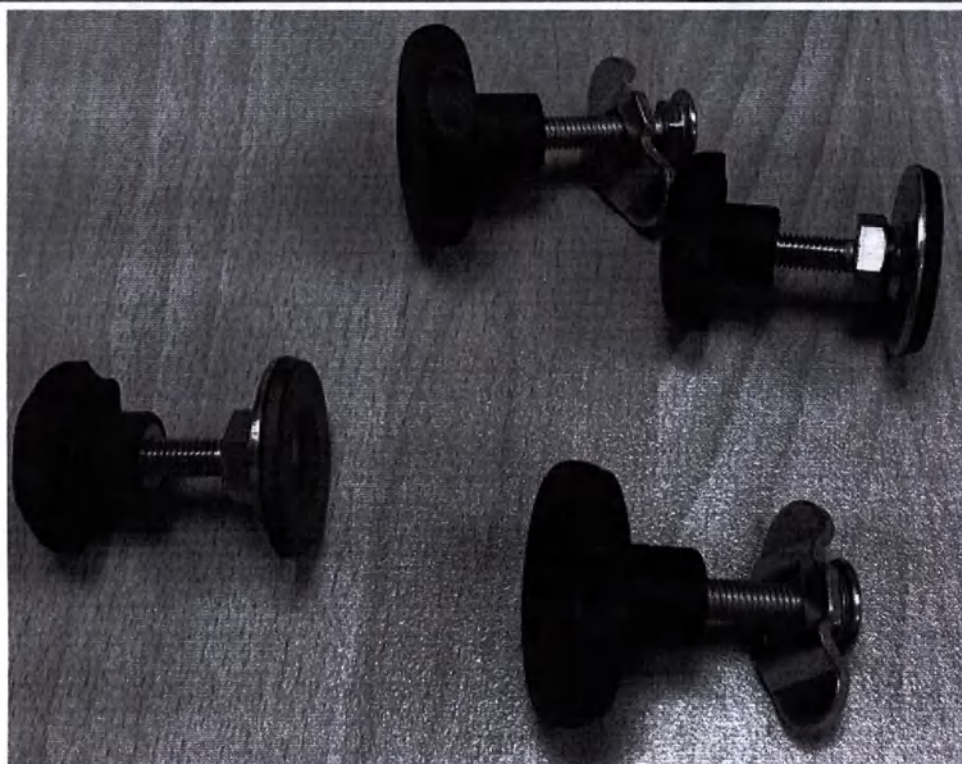
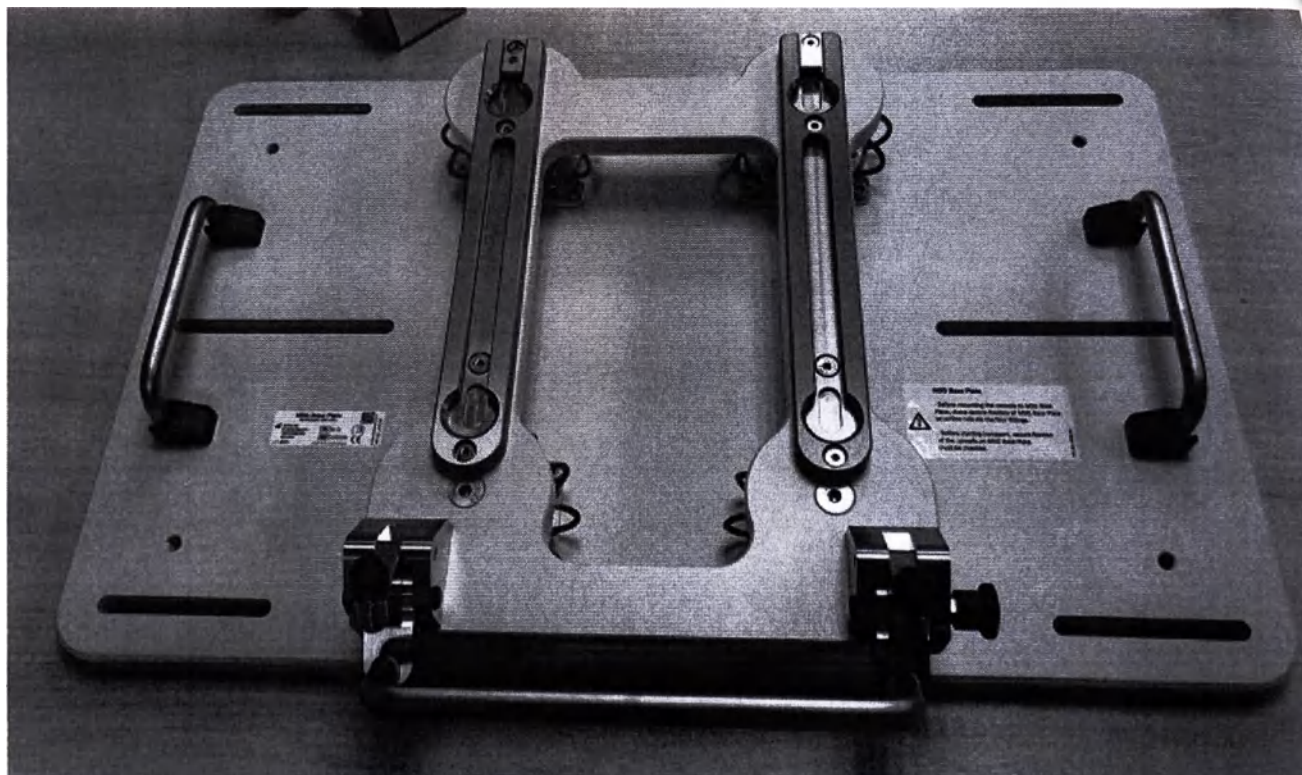


Фото 59 - Опорная площадка MSG (MSG Base Plate) – внешний вид образца



Фото 60 - Опорная площадка MSG (MSG Base Plate) – маркировка образца

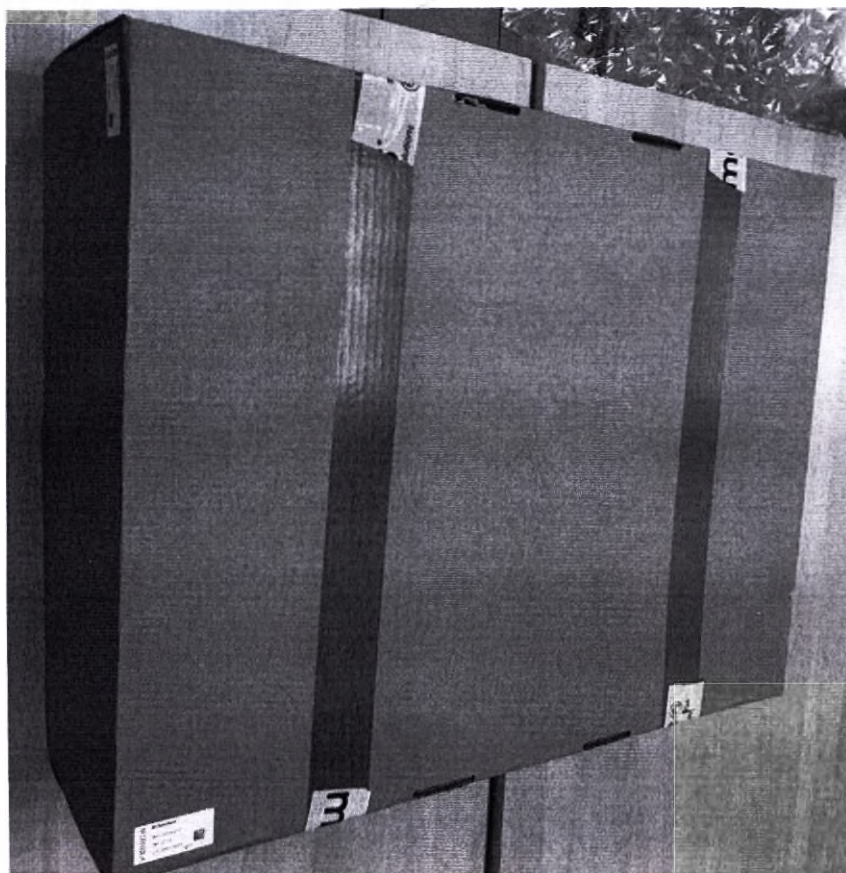


Фото 61 - Резервный модуль MSG (MSG Backup Module) – внешний вид упаковки



ООО Испытательный лабораторный центр «МедТестПрибор»
Аттестат аккредитации: РОСС RU.0001.21МП26 от 22.07.2015

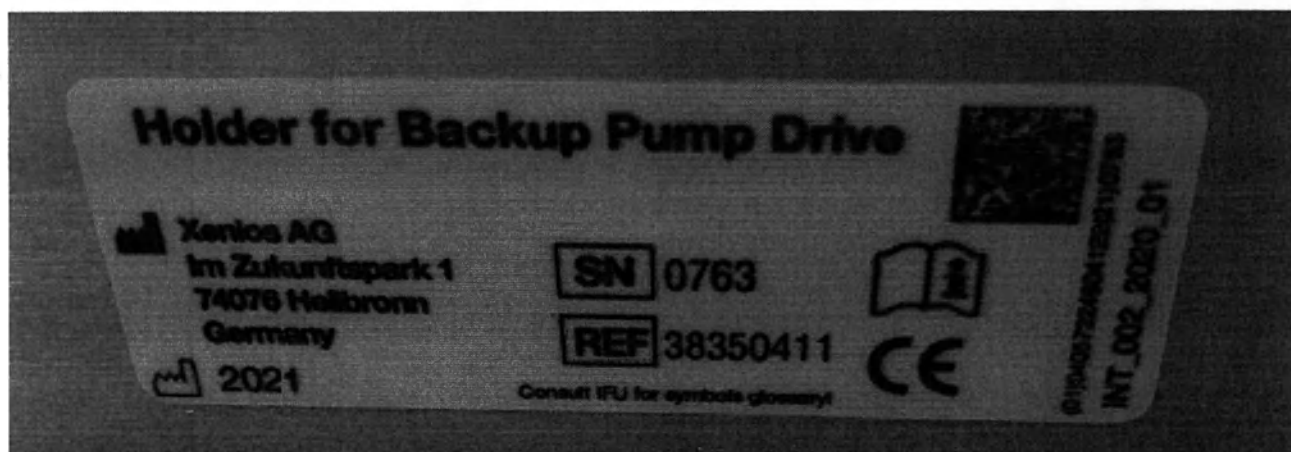
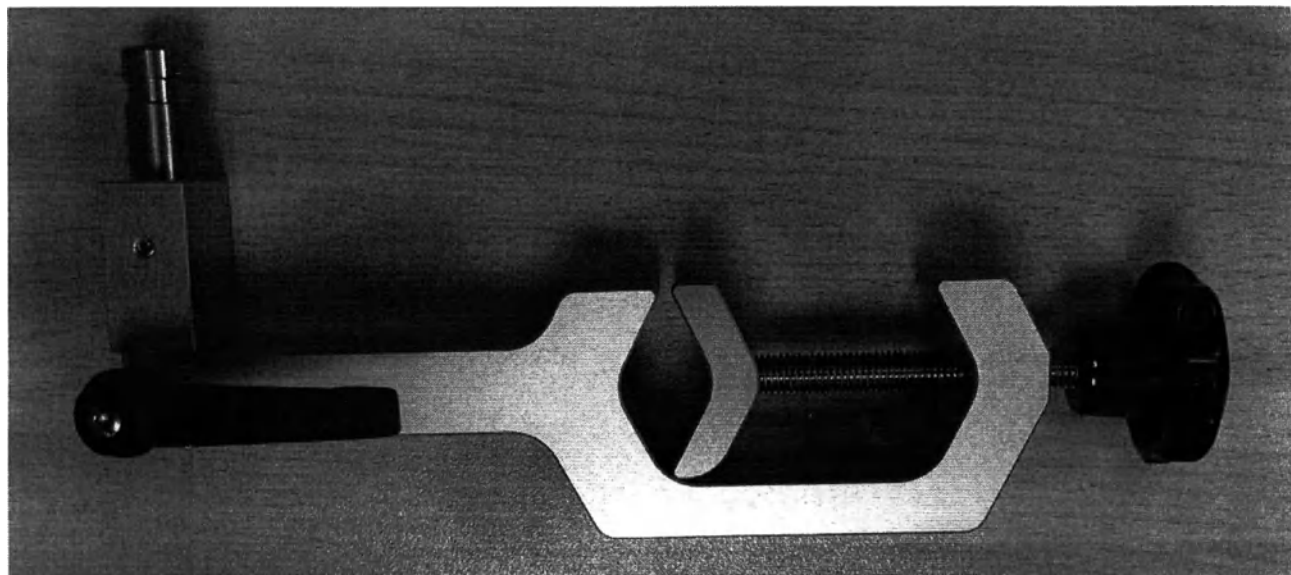


Фото 53- Держатель привода резервного насоса (Holder for backup pump drive) – внешний вид и маркировка образца

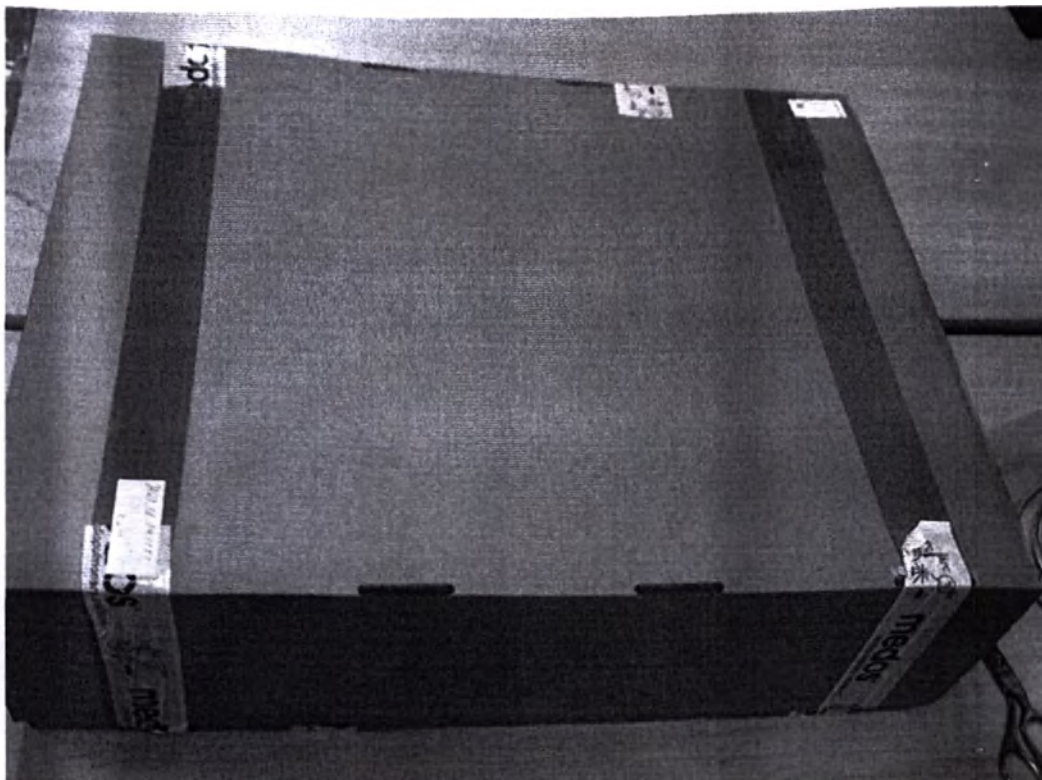


Фото 54 - Держатель привода насоса MSG (MSG Holder) – внешний вид упаковки

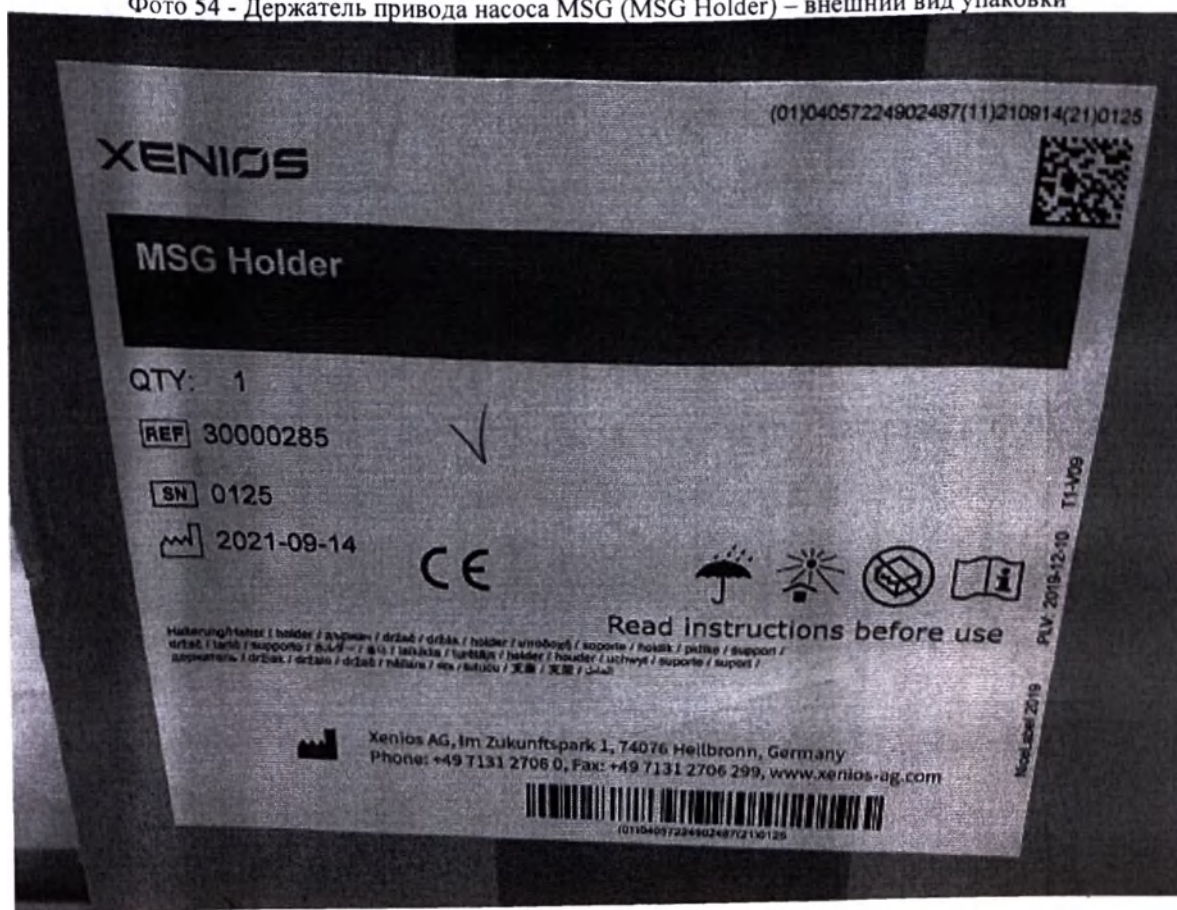


Фото 55 - Держатель привода насоса MSG (MSG Holder) – маркировка упаковки



ООО Испытательный лабораторный центр «МедТестПрибор»
 Аттестат аккредитации: РОСС RU.0001.21МП26 от 22.07.2015



Фото 56 - Держатель привода насоса MSG (MSG Holder) – внешний вид и маркировка образца

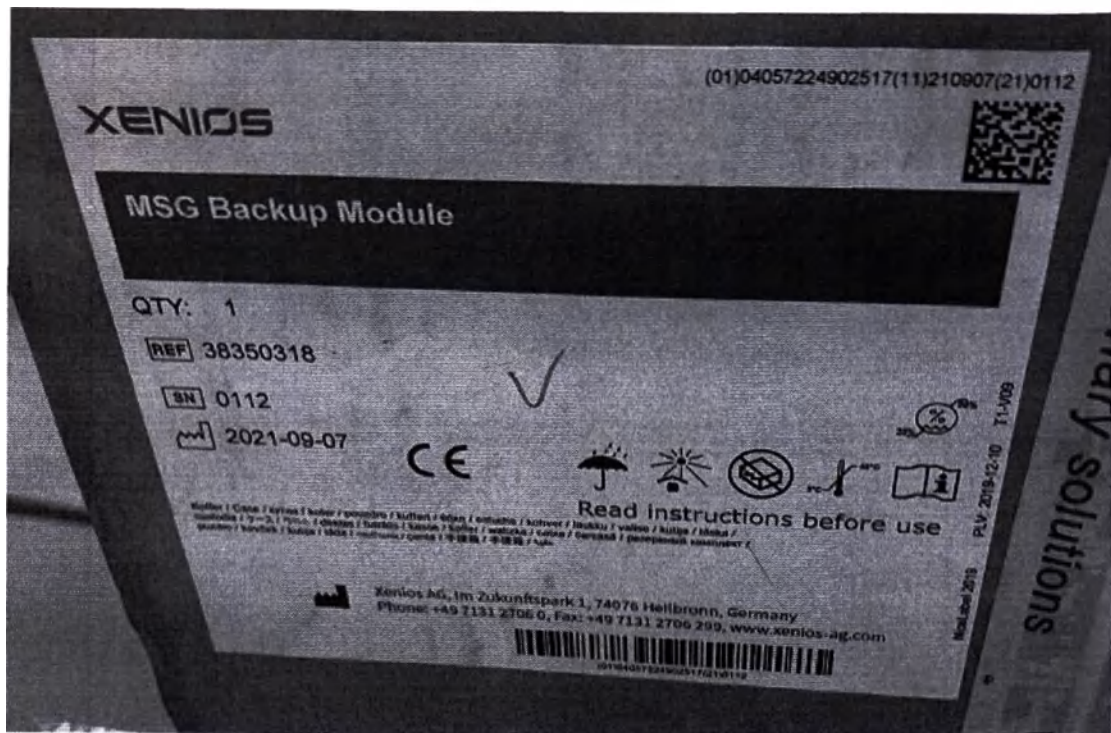


Фото 62 - Резервный модуль MSG (MSG Backup Module) – маркировка упаковки


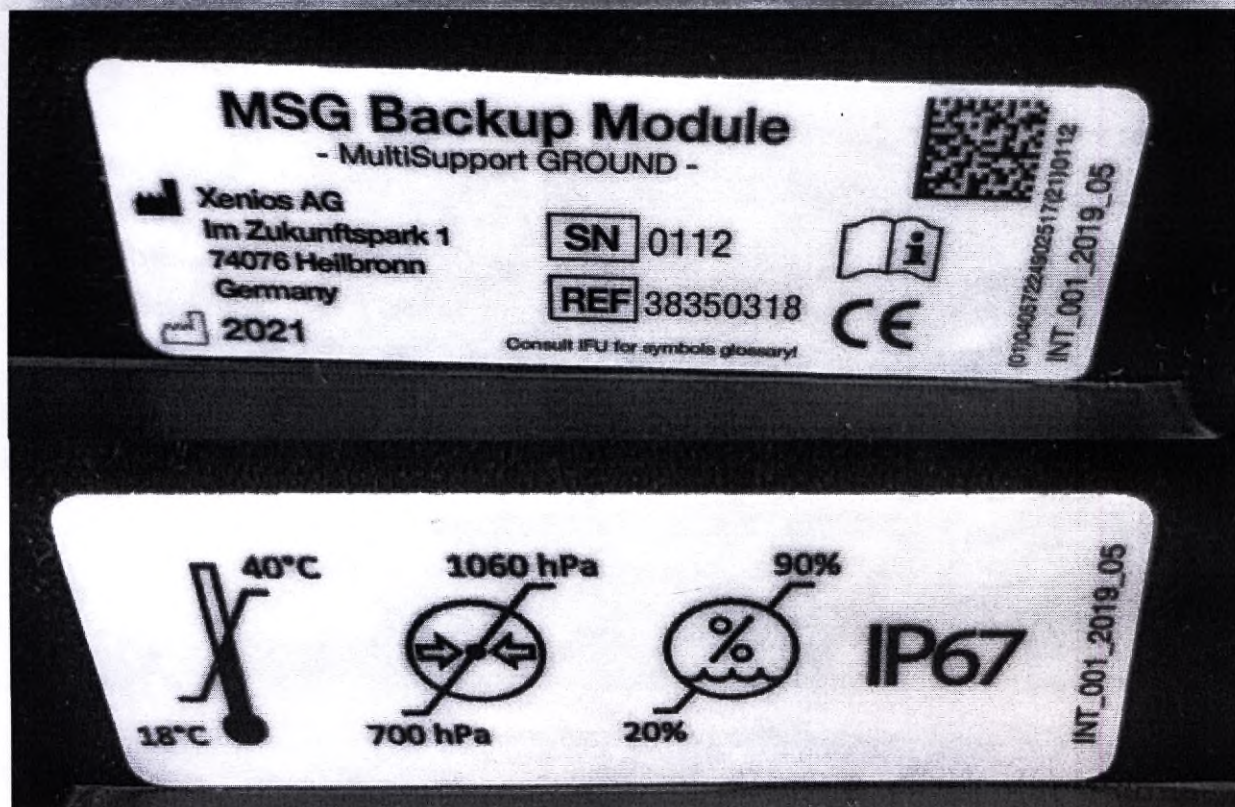


Фото – Резервный модуль MSG– внешний вид и маркировки

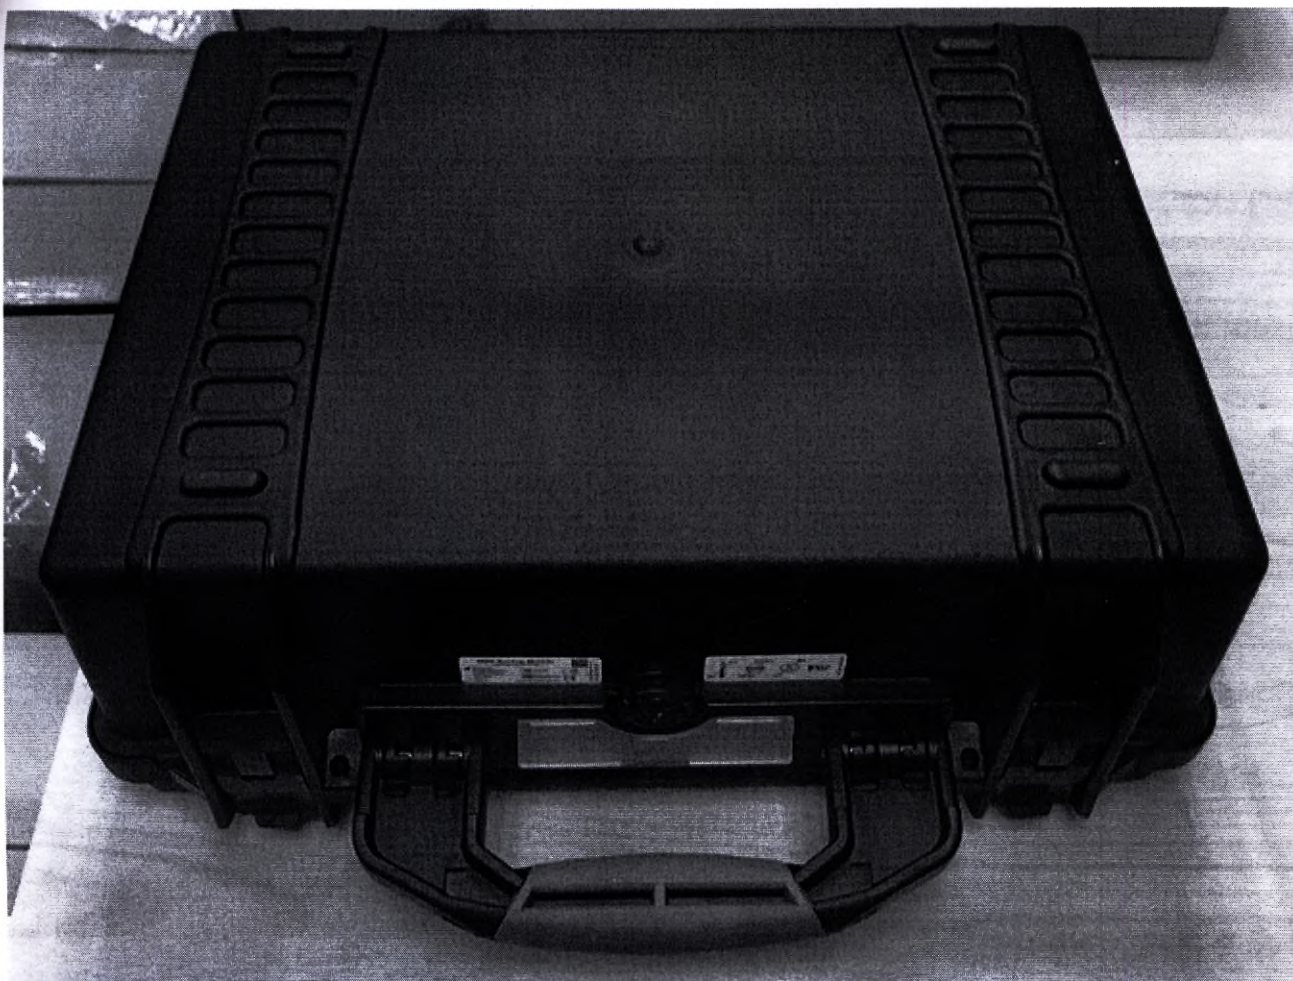

ООО Испытательный лабораторный центр «МедТестПрибор»
Аттестат аккредитации: РОСС RU.0001.21МП26 от 22.07.2015

Фотографические изображения «Устройство для вспомогательного кровообращения Xenios Console с принадлежностями»


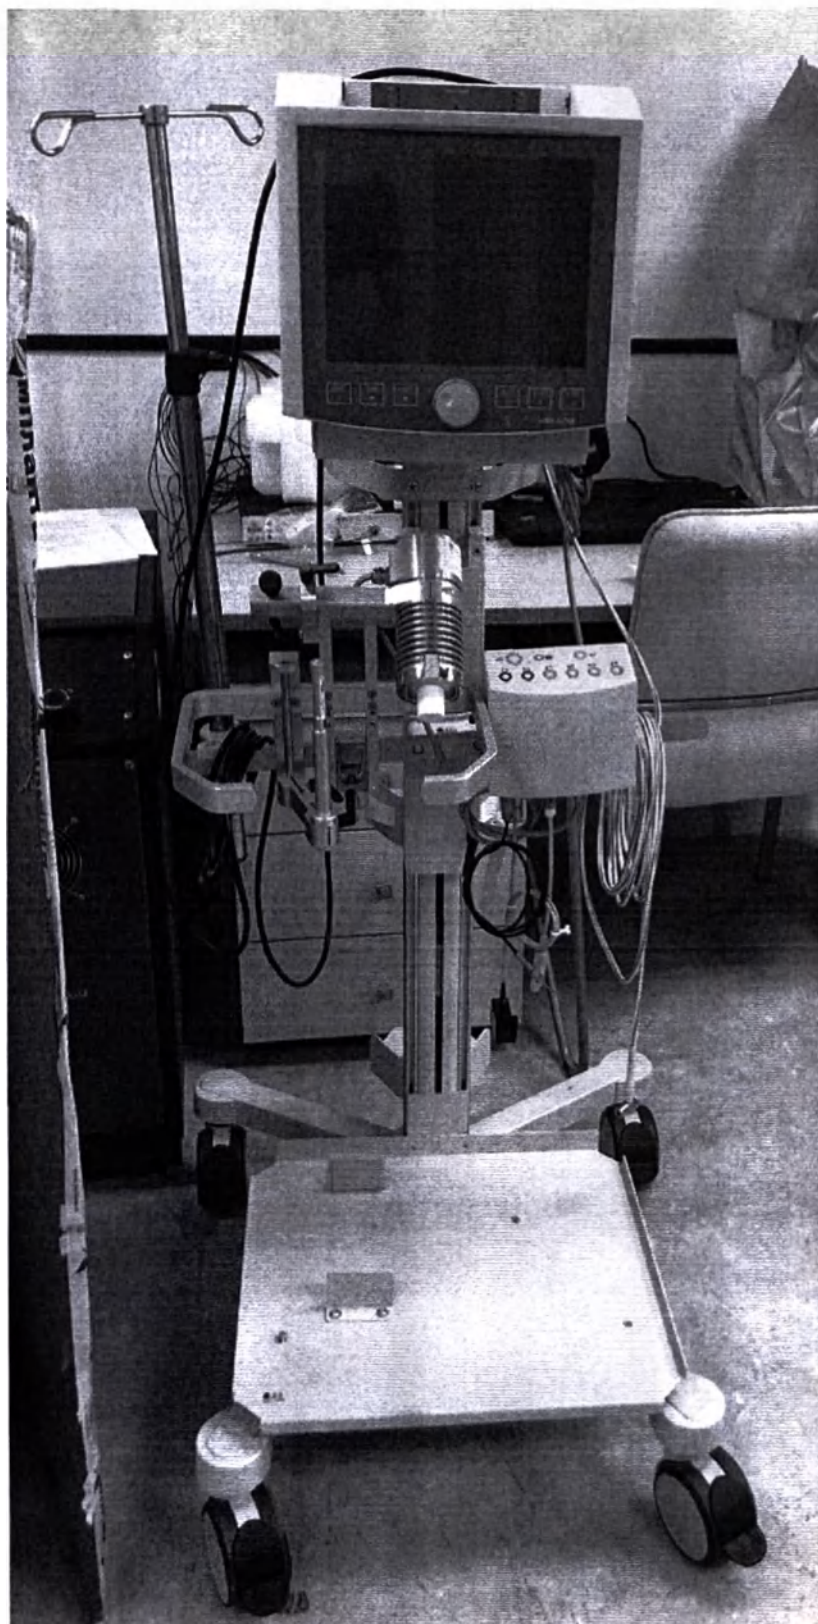


Фото 1 – Общий внешний вид изделия



ООО Испытательный лабораторный центр «МедТестПрибор»
Аттестат аккредитации: РОСС RU.0001.21МП26 от 22.07.2015

Всего пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью 36 лис



В.А. Коче





Фото 63 – Резервный модуль MSG– внешний вид состава



ООО Испытательный лабораторный центр «МедТестПрибор»
Аттестат аккредитации: РОСС RU.0001.21МП26 от 22.07.2015

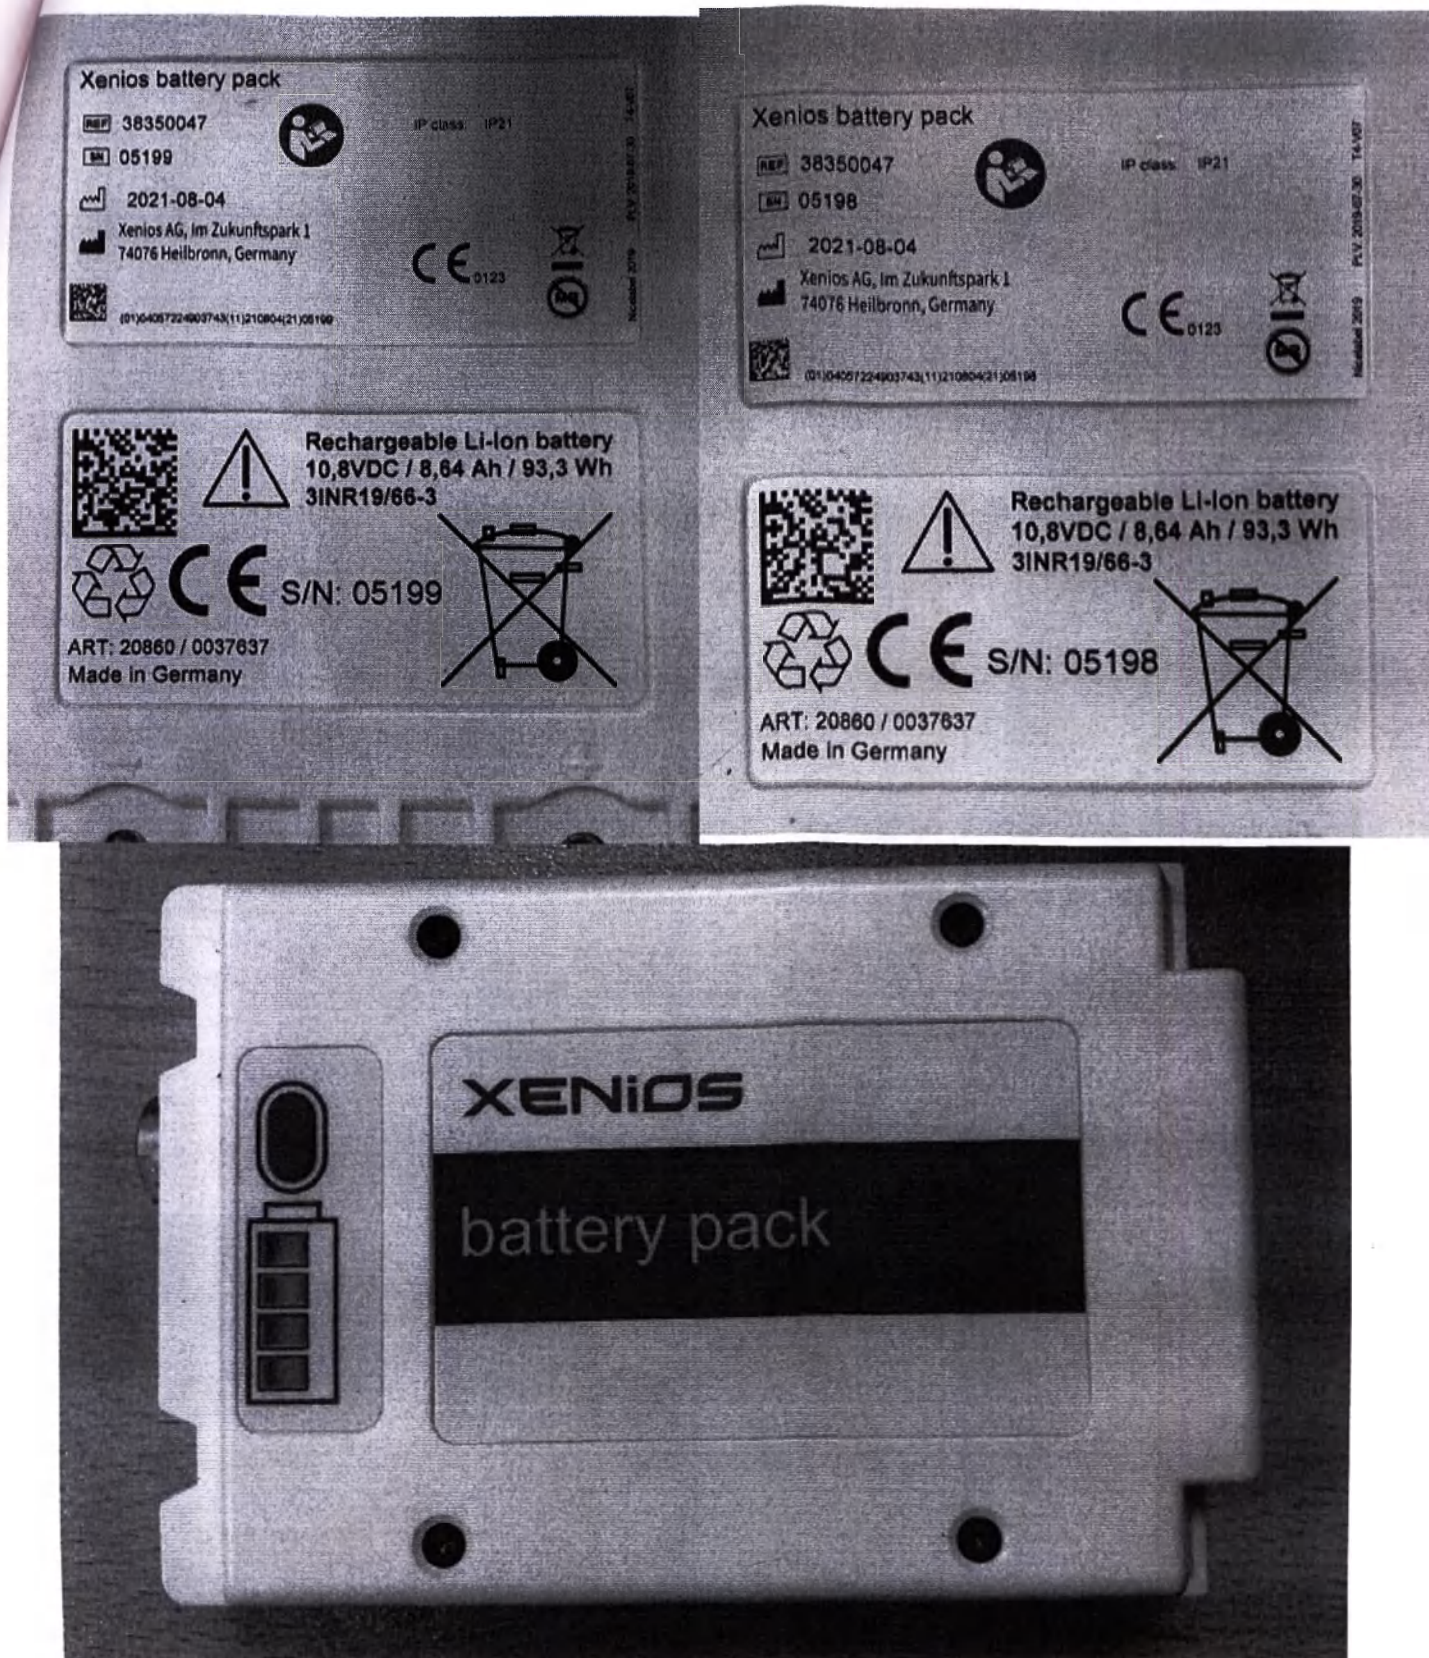


Фото 64- Резервный модуль MSG: Резервные аккумуляторные батареи (Backup Battery Pack) – внешний вид и маркировка

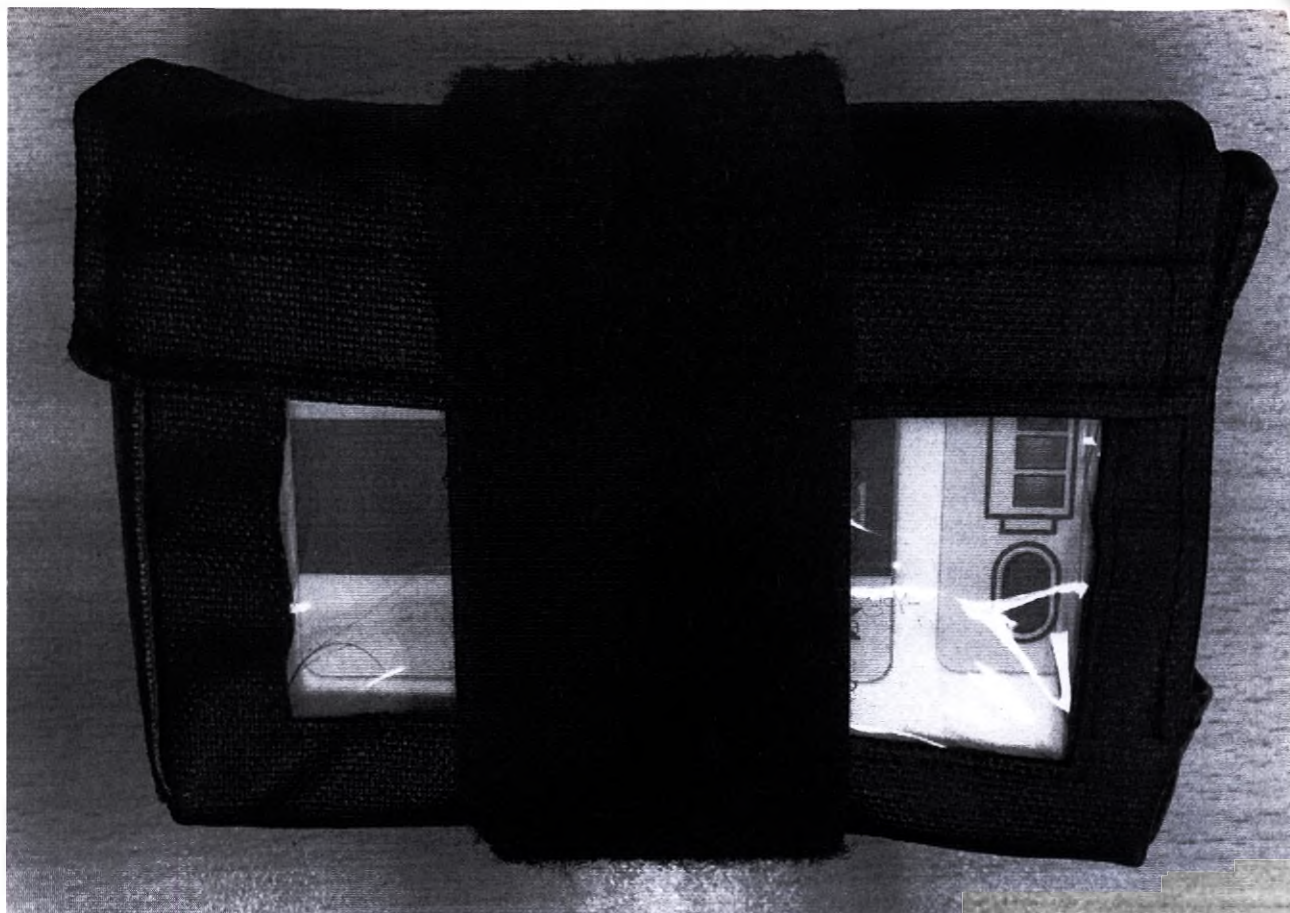


Фото 65 - Резервный модуль MSG: Сумка для резервных аккумуляторных батарей (MSG Battery Case) – внешний вид



Фото 66- Резервный модуль MSG: Кабель питания MSG (MSG Power cable) – внешний вид

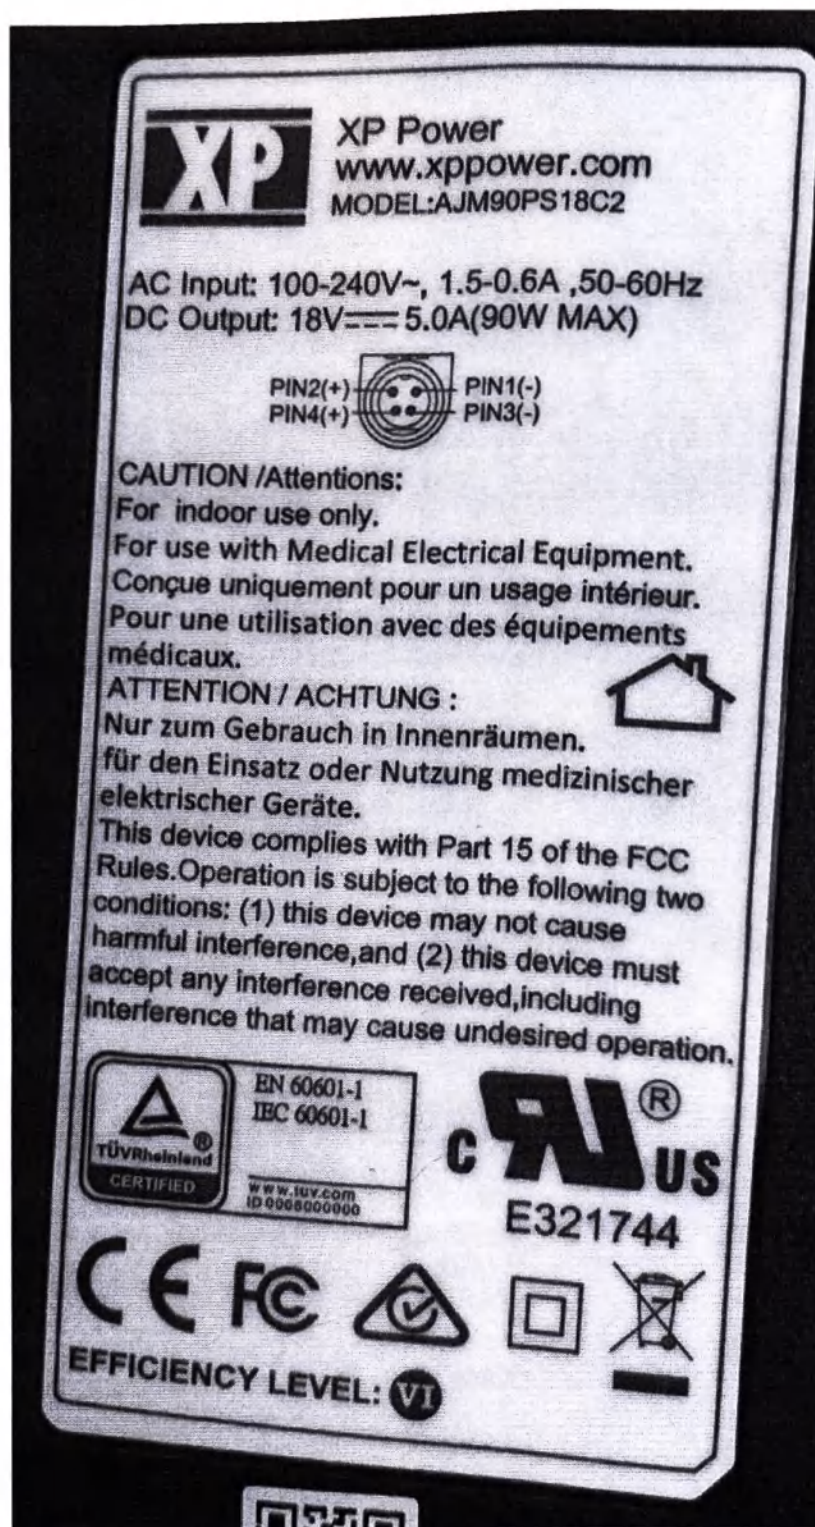


Фото 67- Резервный модуль MSG: Кабель питания MSG (MSG Power cable) – маркировка образца



ООО Испытательный лабораторный центр «МедТестПрибор»
 Аттестат аккредитации: РОСС RU.0001.21МП26 от 22.07.2015



Фото 68- Резервный модуль MSG: Защитный чехол от влаги (MSG Rain Cover) – внешний вид и маркировка образца



Фото 69 - Резервный модуль MSG: Зажим для магистралей (MSG Tubing Clamps) – внешний вид и маркировка образца

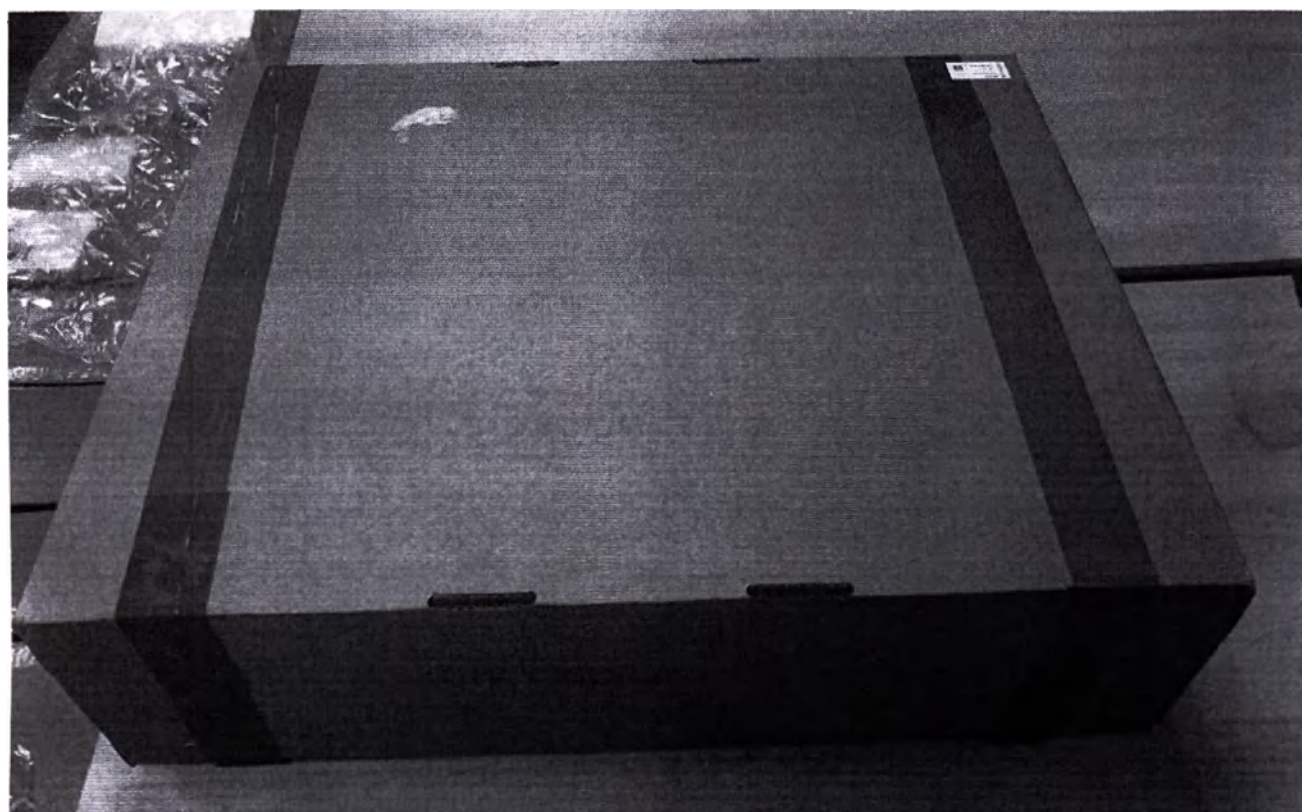


Фото 70 - Горизонтальный держатель MSG (MSG Crossbar) – внешний вид упаковки



ООО Испытательный лабораторный центр «МедТестПрибор»
Аттестат аккредитации: РОСС RU.0001.21МП26 от 22.07.2015

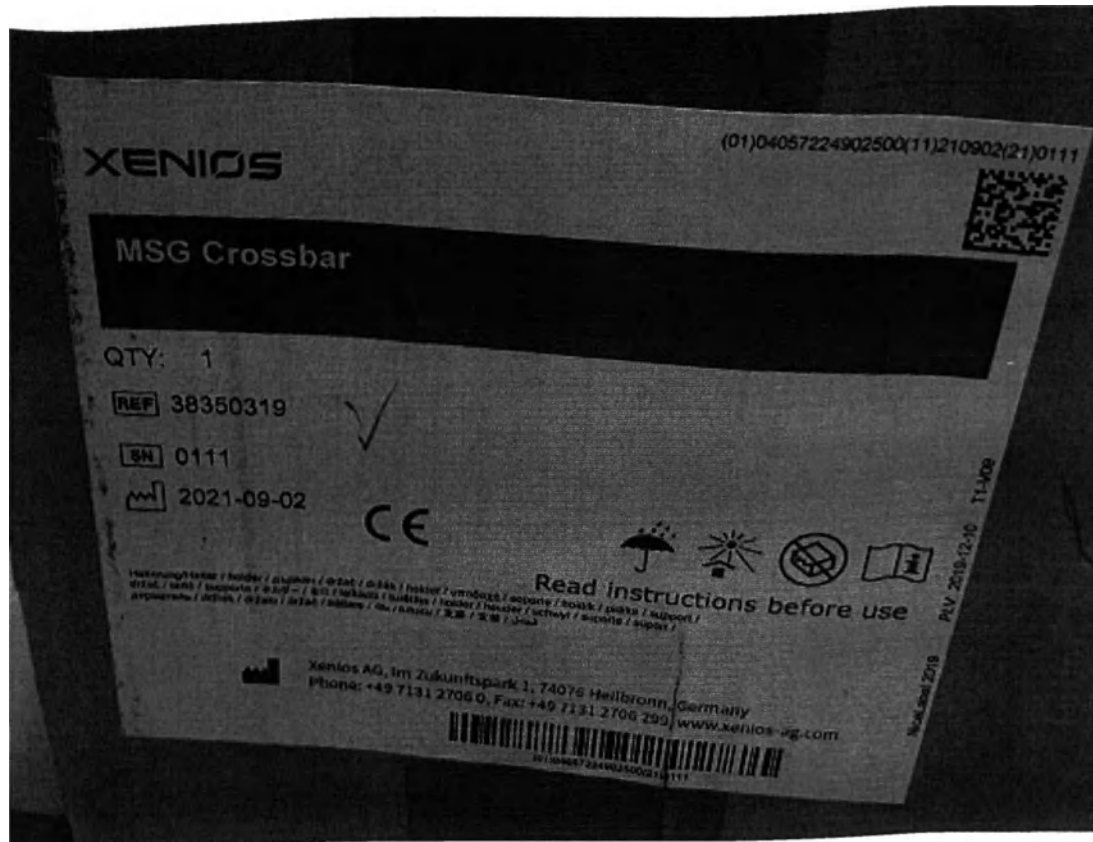


Фото 71- Горизонтальный держатель MSG (MSG Crossbar) – маркировка упаковки

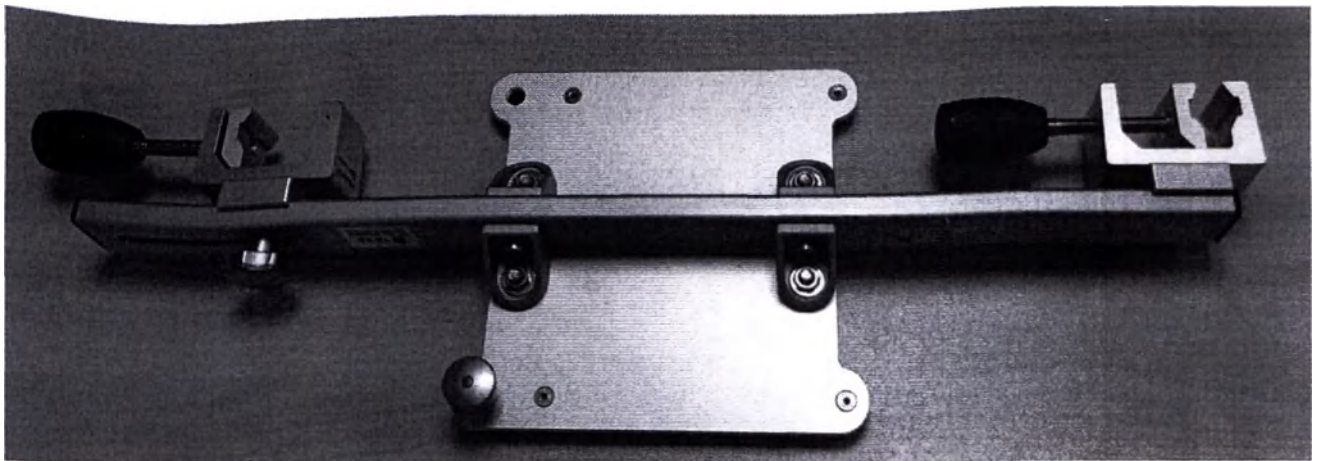


Фото 72 - Горизонтальный держатель MSG (MSG Crossbar) – внешний вид образца

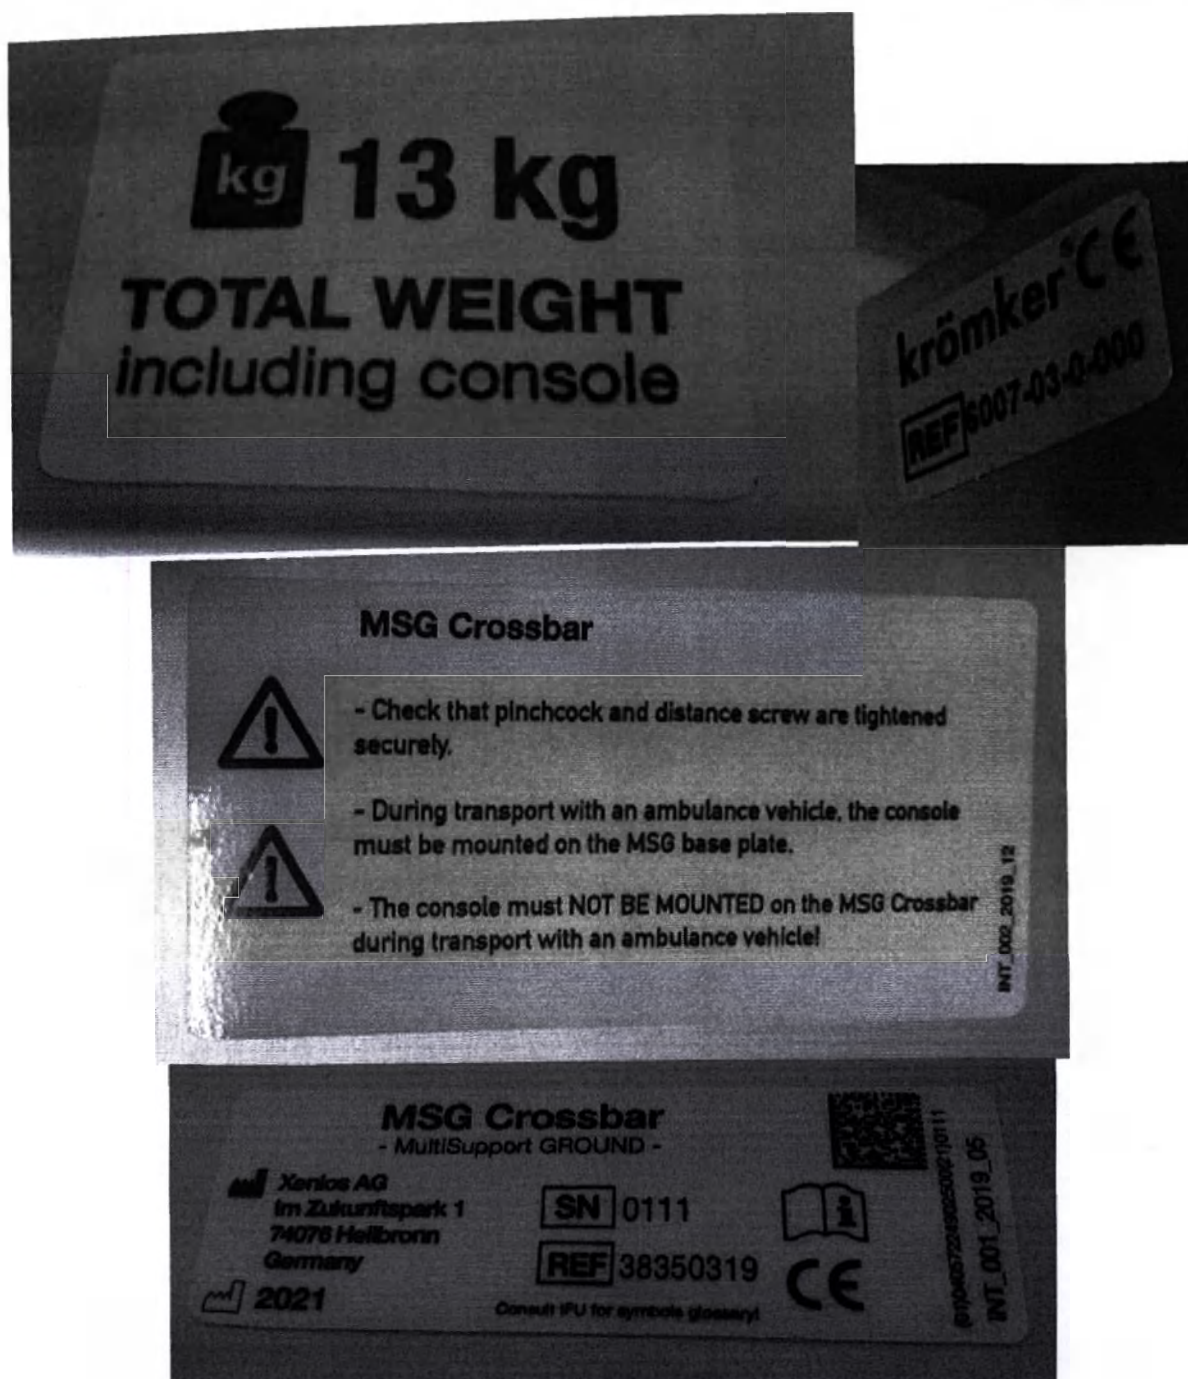


Фото 73- Горизонтальный держатель MSG (MSG Crossbar) – маркировка образца



ООО Испытательный лабораторный центр «МедТестПрибор»
Аттестат аккредитации: РОСС RU.0001.21МП26 от 22.07.2015

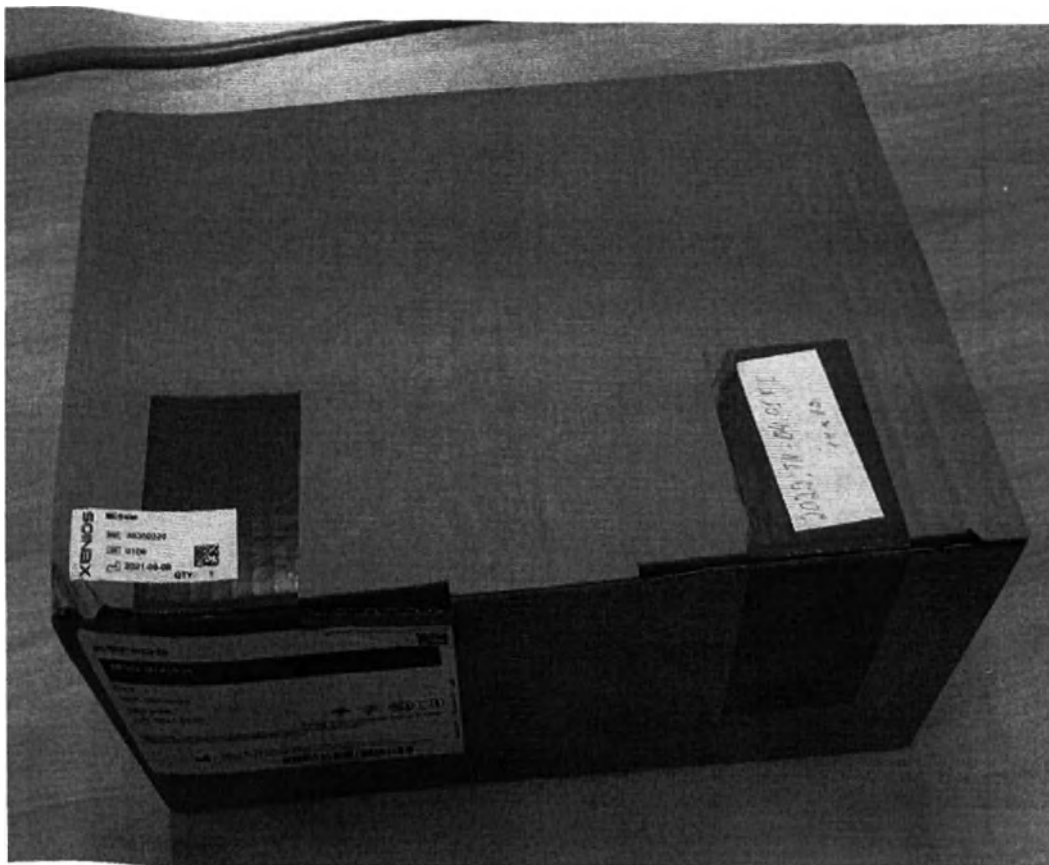


Фото 74 - Держатель MSG (MSG Bracket) – внешний вид упаковки

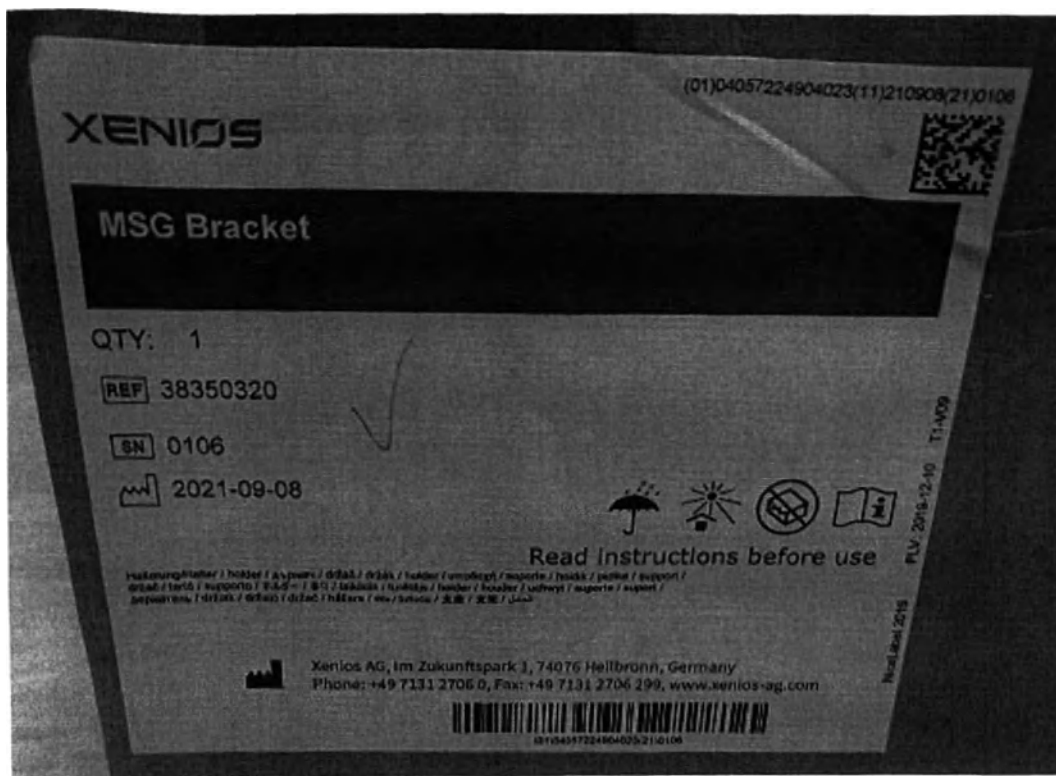




Фото 75 - Держатель MSG (MSG Bracket) – маркировка упаковки

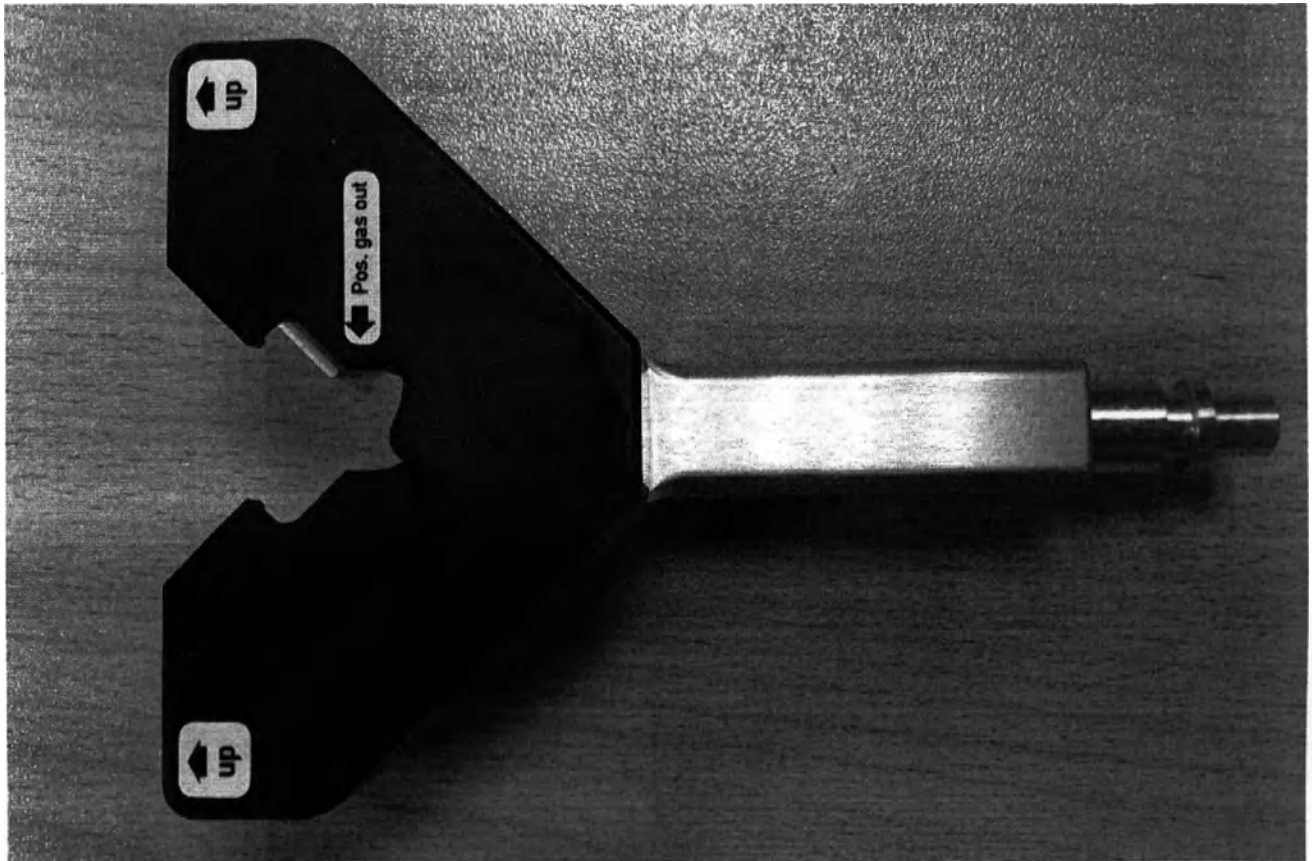


Фото 76- Держатель MSG (MSG Bracket) – внешний вид образца



Фото 77 - Адаптер держателя MSG 2400 (MSG Pin 2400) – внешний вид и маркировка упаковки



Фото 78- адаптер держателя MSG 2400 (MSG Pin 2400) – внешний вид и маркировка образца



Фото 79 - Адаптер MSG к тележке (MSG Platform Adaption Kit) – внешний вид упаковки

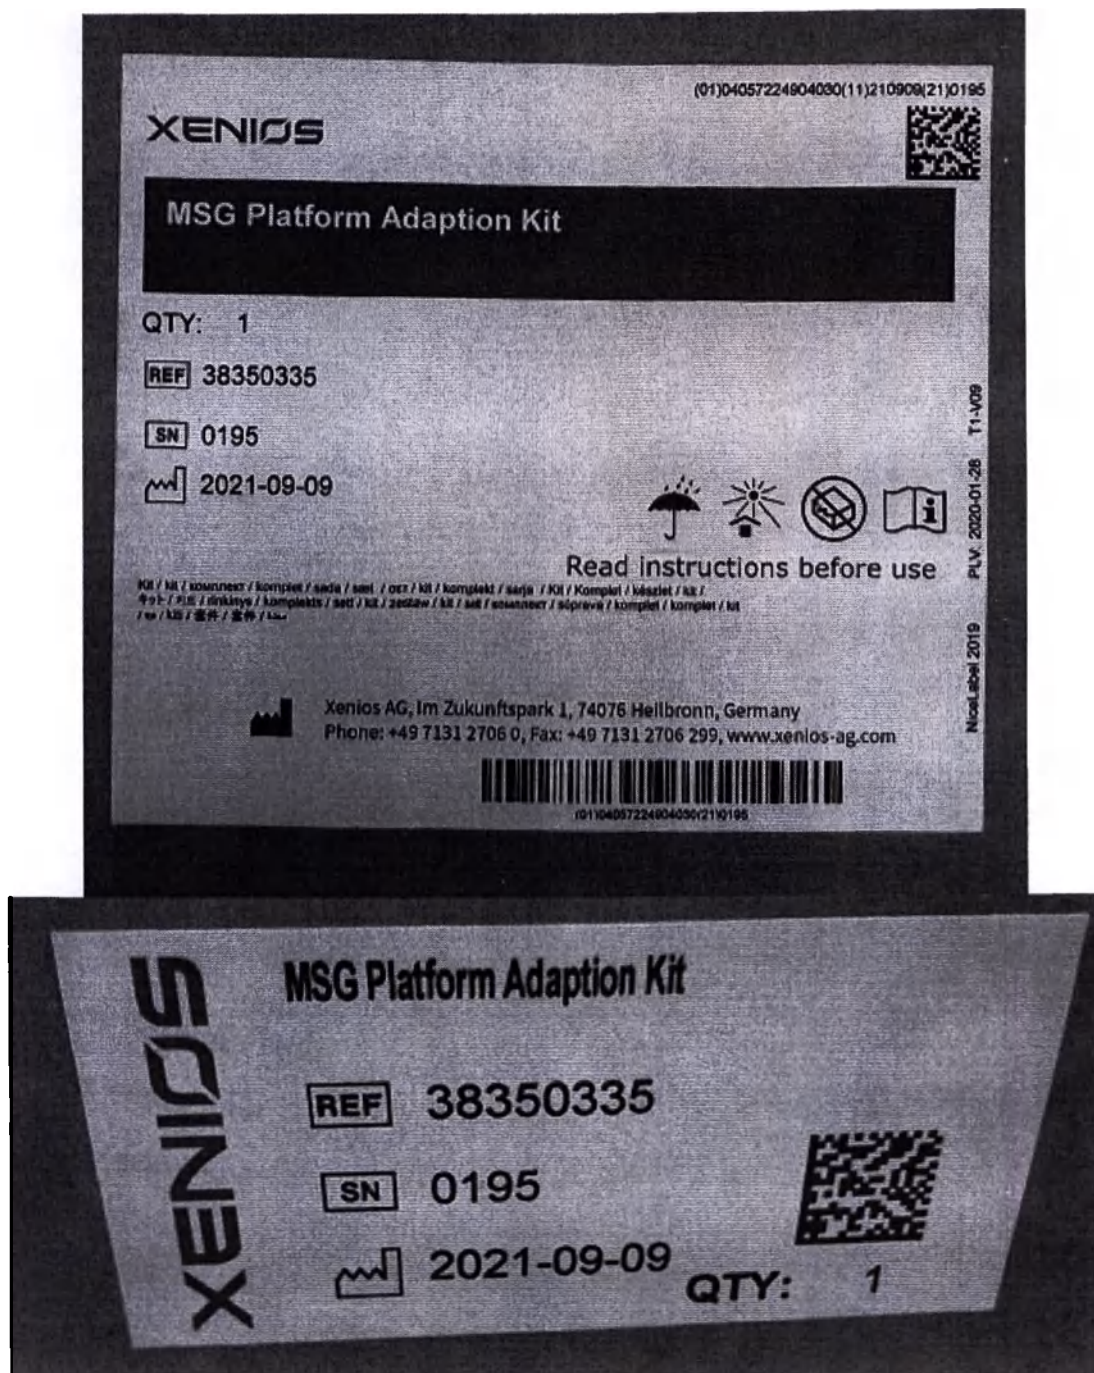


Фото 80 - Адаптер MSG к тележке (MSG Platform Adaption Kit) – маркировка упаковки

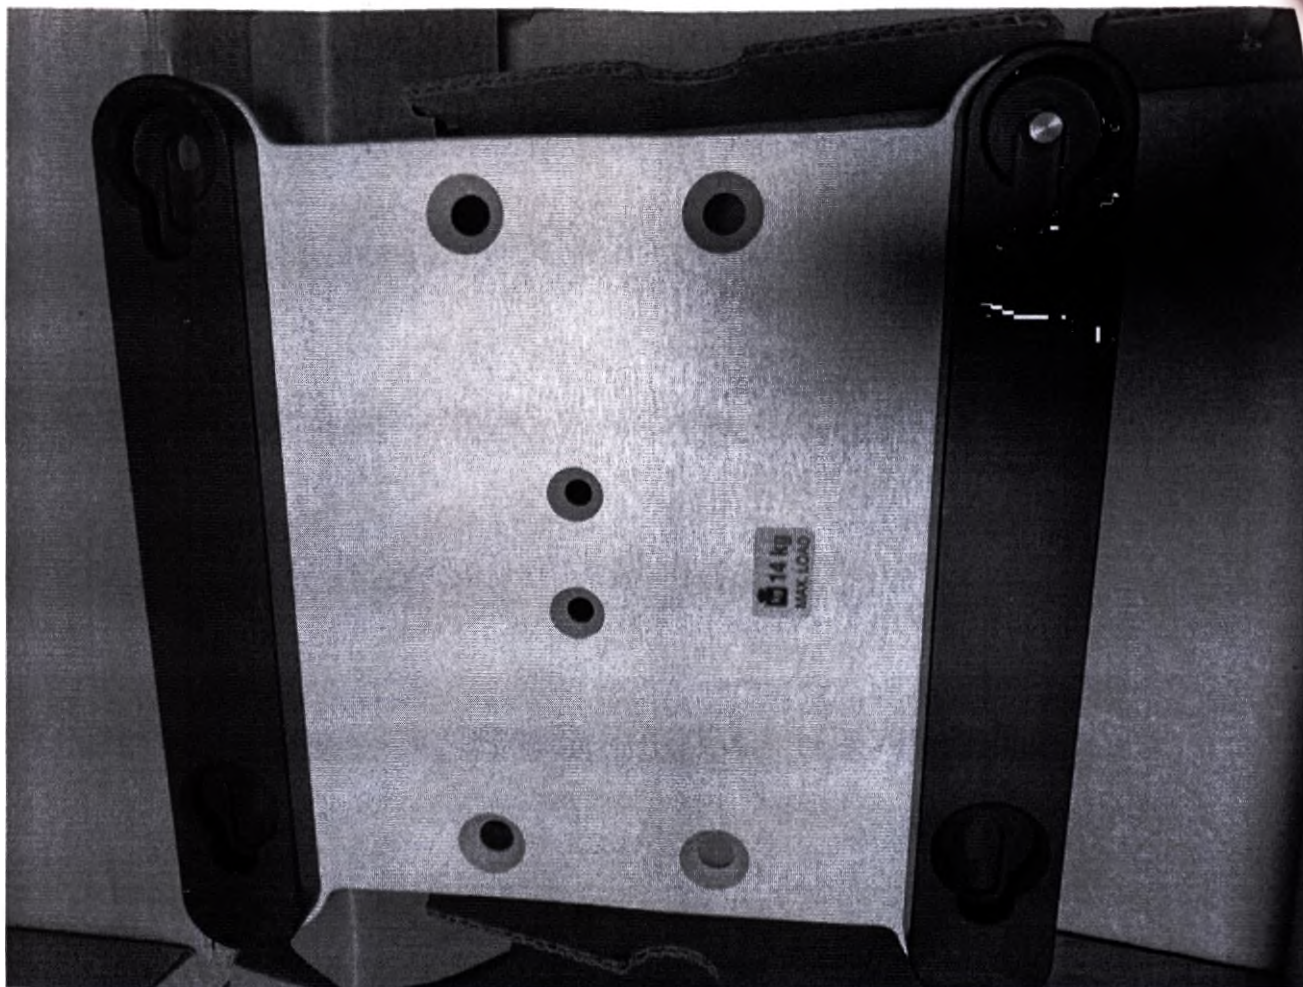


Фото 81- Адаптер MSG к тележке (MSG Platform Adaption Kit) – внешний вид образца



Фото 82 - Адаптер MSG к тележке (MSG Platform Adaption Kit) – маркировка образца

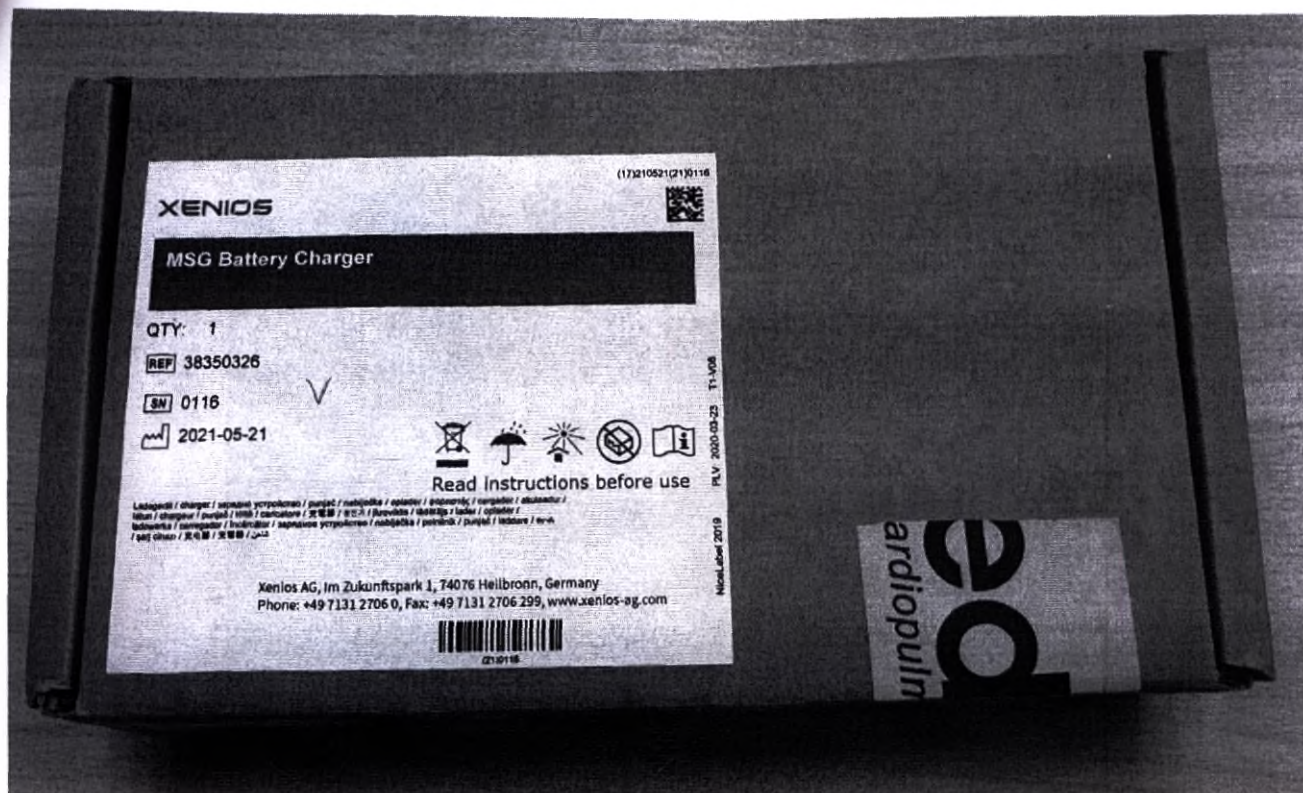


Фото 83 - Зарядное устройство MSG (MSG battery charger) – внешний вид и маркировка упаковки



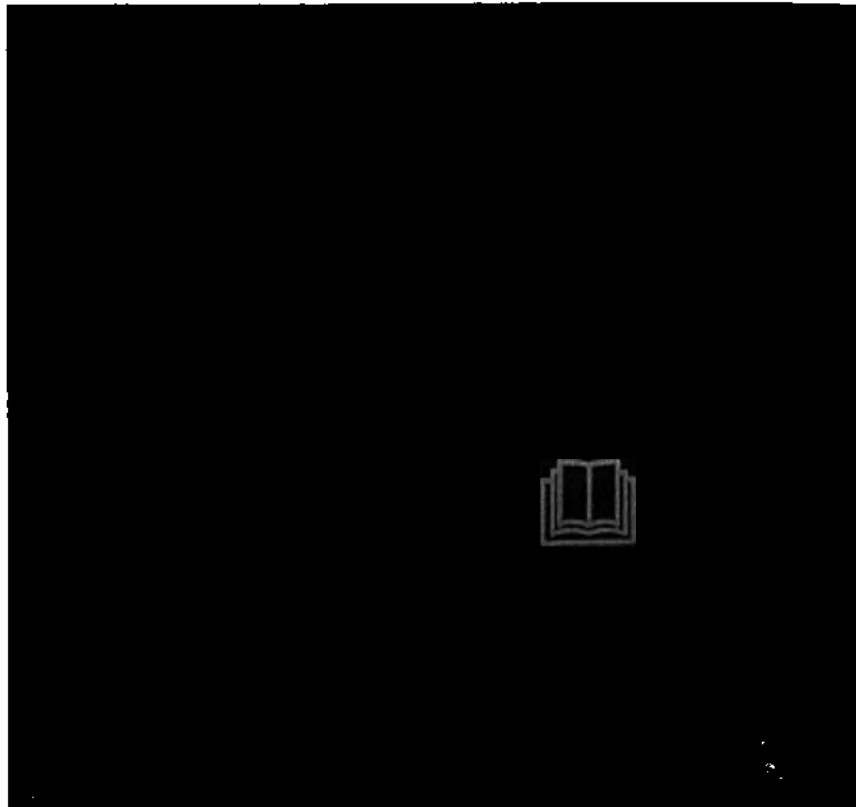


Фото 84- Зарядное устройство MSG (MSG battery charger) – внешний вид и маркировка образца

Макет маркировки на русском языке

Устройство для вспомогательного кровообращения Xenios Console в составе

РУ № _____ от _____ г.



XENIOS AG / КСЕНИОС АГ

Im Zukunftspark 1, 74076 Heilbronn, Germany (Германия)

Место производства: XENIOS AG, Im Zukunftspark 1, 74076 Heilbronn, Germany


Уполномоченный представитель производителя в РФ: ЗАО «ИМПЛАНТА»,
119002 Москва, Карманицкий пер., 9, тел. + 7 (495) 234-91-19, E-mail: info@implanta.ru



ООО Испытательный лабораторный центр «МедТестПрибор»
Аттестат аккредитации: РОСС RU.0001.21МП26 от 22.07.2015

Фотографические изображения интерфейса программного обеспечения

ООО Испытательный лабораторный центр «МедТестПрибор»
Аттестат аккредитации: РОСС RU.0001.21МП26 от 22.07.2015

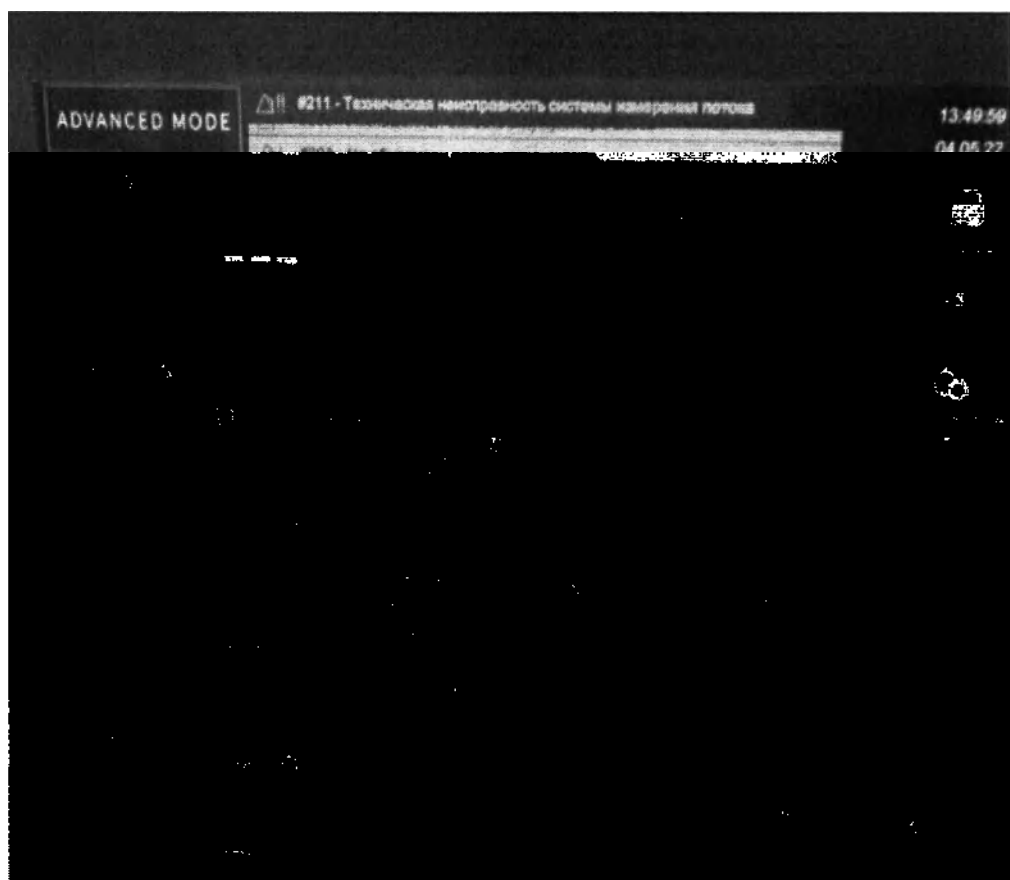

ООО Испытательный лабораторный центр «МедТестПрибор»
Аттестат аккредитации: РОСС RU.0001.21МП26 от 22.07.2015