

Фотографические изображения общего вида на медицинское изделие:

Разбавитель образца для количественного определения электролитов в сыворотке, плазме крови или моче человека потенциометрическим методом с помощью ICT-модуля на биохимических анализаторах Alinity с "ICT модуль Разбавитель образца (Alinity с ICT Sample Diluent)"

(размером не менее 18 x 24 сантиметра)

Фотографические изображения Разбавитель образца для количественного определения электролитов в сыворотке, плазме крови или моче человека потенциометрическим методом с помощью ICT-модуля на биохимических анализаторах Alinity c "ICT модуль Разбавитель образца (Alinity c ICT Sample Diluent)"

Alinity c ICT Sample Diluent



ICT Diluent




07P5320



10 x 935

15°C



30°C



10 x 68.2 mL



www.abbottdiagnostics.com/1FU

R01



2018-08-27



42069UN17




G70141R01

(01) 00380740121686 (17) 180827

(10) 42069UN17 (240) 07P5320

Фотографические изображения Разбавитель образца для количественного определения электролитов в сыворотке, плазме крови или моче человека потенциометрическим методом с помощью ICT-модуля на биохимических анализаторах Alinity с "ICT модуль Разбавитель образца (Alinity с ICT Sample Diluent)"

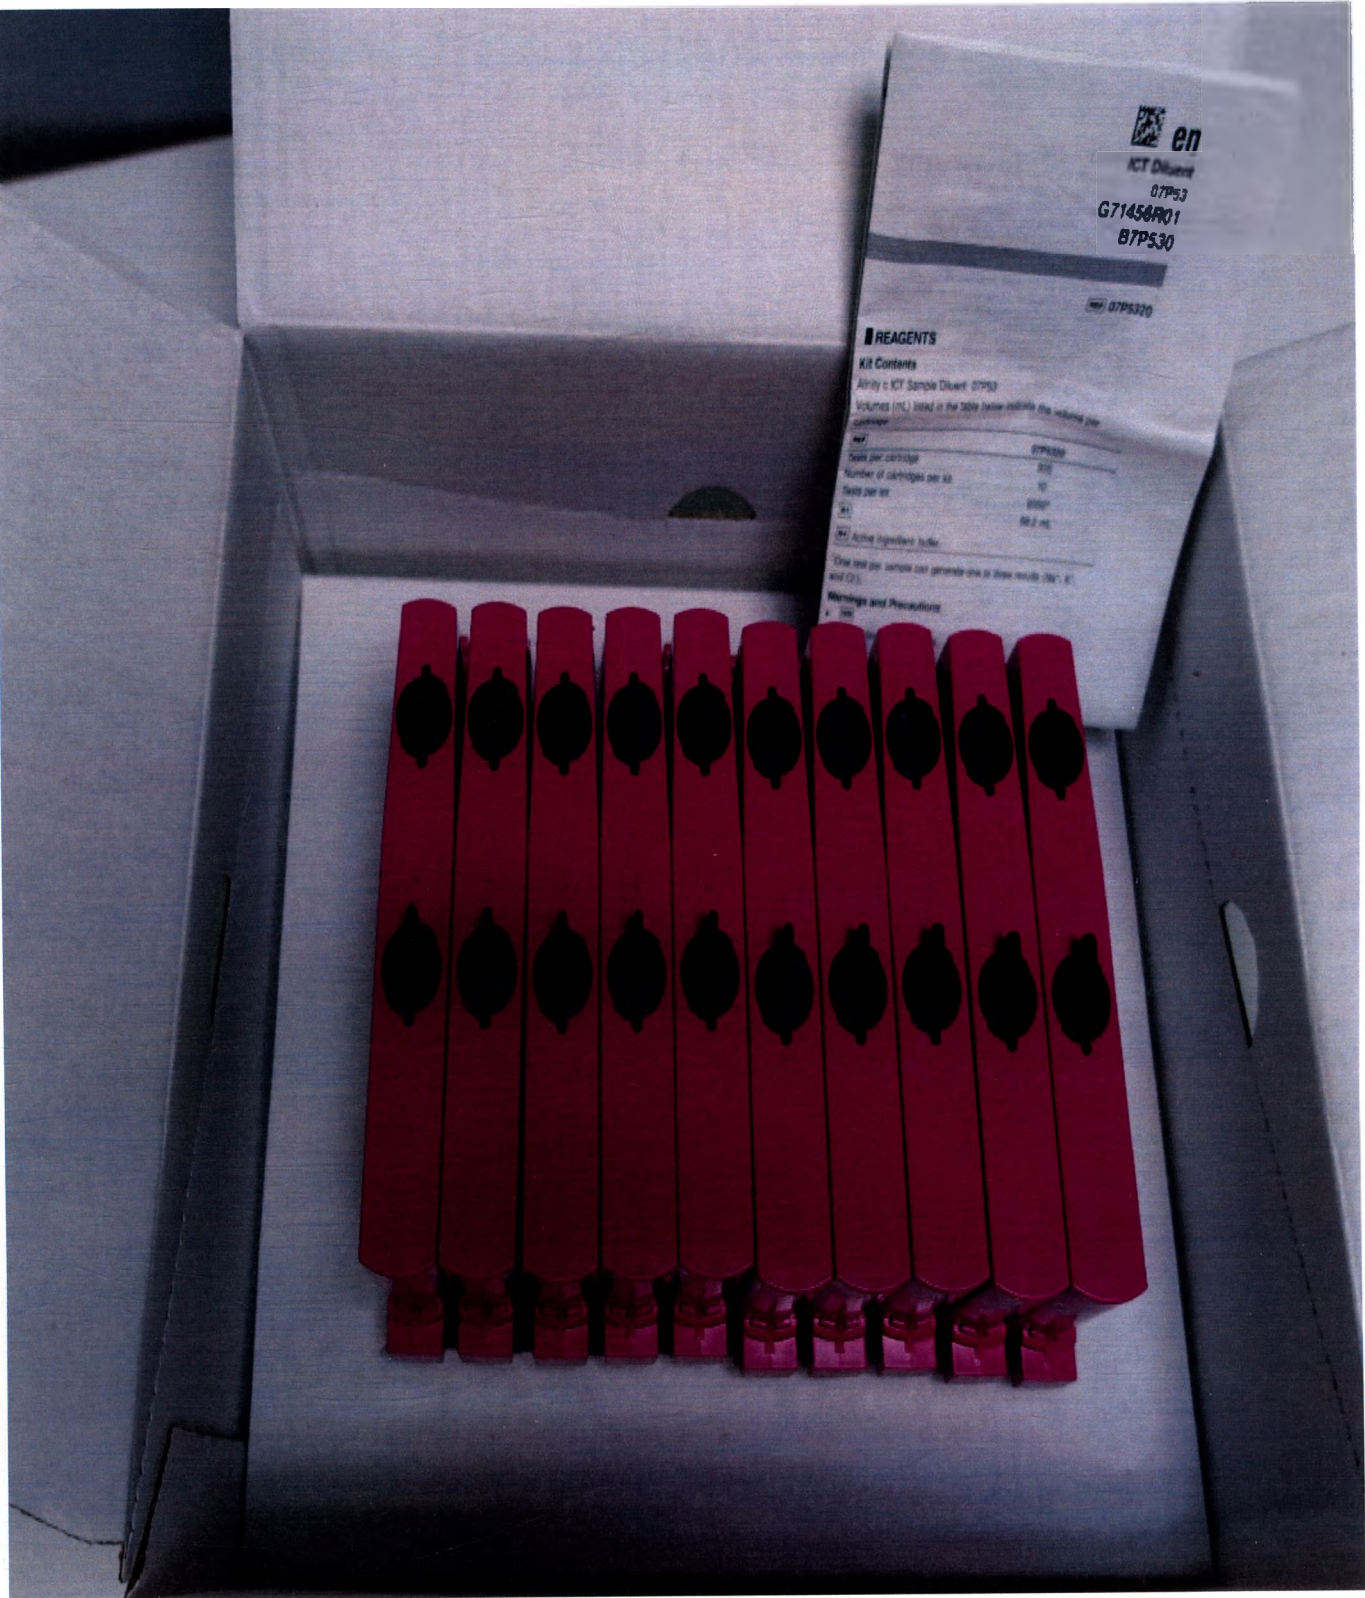

Фотографические изображения Разбавитель образца для количественного определения электролитов в сыворотке, плазме крови или моче человека потенциометрическим методом с помощью ICT-модуля на биохимических анализаторах Alinity с "ICT модуль Разбавитель образца (Alinity с ICT Sample Diluent)"



Всего прошито, пронумеровано

и скреплено печатью

листов



Макет маркировки на медицинское изделие для диагностики in vitro на русском языке

Разбавитель образца для количественного определения электролитов в сыворотке, плазме крови или моче человека потенциометрическим методом с помощью ICT-модуля на биохимических анализаторах Alinity с "ICT модуль Разбавитель образца (Alinity с ICT Sample Diluent)"

Авторизованный представитель изготовителя на территории России и других стран СНГ: Общество с ограниченной ответственностью «Эбботт Лэбораториз», 125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, 16А, строение 1, Тел.: +7 (495) 258 42 80; Факс: +7 (495) 258 42 81.1.

File:	C:\PS3 TF-20_Erg_P01a.mxd
Template:	Alinity.c4c\Cartridge KLA_Template.rvt
Size:	225 mm x 58 mm Drawing: AK4499
Colors:	Refer to the drawing for stamp labels and materials
Material:	Text, Symbols: Black Burching: PMS 233 Text reversed
	Refer to drawing



Alinity ^c

R1

68.2 mL



ABBOTT
65205 Wiesbaden, Germany
G71115R01

SN


00000



Alinity ^c

R1

68,2 мл



ABBOTT
65205 Wiesbaden, Germany

G71115R01

SN

00000

ICT Diluent

ICT Sample Diluent

07P53



IVD

Exp. 2099-12-31
LOT 12345100

Abbott

G71052R01

ICT Diluent

ICT модуль Разбавитель образца (Alinity c ICT Sample Diluent)

07P53



IVD

Exp. 2099-12-31
LOT 12345100

Abbott

G71052R01

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью _____ листов

