

Фотографические изображения общего вида на медицинское изделие:

**Набор калибраторов для обеспечения правильности количественного определения электролитов в сыворотке крови человека потенциометрическим методом с помощью ICT- модуля на биохимических анализаторах Alinity с "ICT модуль Калибраторы для сыворотки крови (Alinity с ICT Serum Calibrator Kit)"**

(размером не менее 18 x 24 сантиметра)

Фотографические изображения Набор калибраторов для обеспечения правильности количественного определения электролитов в сыворотке крови человека потенциометрическим методом с помощью ICT- модуля на биохимических анализаторах Alinity с "ICT модуль Калибраторы для сыворотки крови (Alinity с ICT Serum Calibrator Kit)"

# Alinity с ICT Serum Calibrator Kit



|       | CONC             |                     |                    |            |
|-------|------------------|---------------------|--------------------|------------|
|       | Sodium<br>mmol/L | Potassium<br>mmol/L | Chloride<br>mmol/L |            |
| CAL L | 120              | 3.4                 | 80                 | 5 x 2.9 mL |
| CAL H | 160              | 8.0                 | 120                | 5 x 2.9 mL |



[www.abbottdiagnostics.com/IFU](http://www.abbottdiagnostics.com/IFU)

R02



REF 08P6901




Exp. 2018-03-20



LOT 13367UN17



G70144R01




(01) 00380740121693 (17) 180320

(10) 13367UN17 (240) 08P6901 (91) ICT

Фотографические изображения Набор калибраторов для обеспечения правильности количественного определения электролитов в сыворотке крови человека потенциометрическим методом с помощью ICT- модуля на биохимических анализаторах Alinity с "ICT модуль Калибраторы для сыворотки крови (Alinity с ICT Serum Calibrator Kit)"




Фотографические изображения Набор калибраторов для обеспечения правильности количественного определения электролитов в сыворотке крови человека потенциометрическим методом с помощью ICT- модуля на биохимических анализаторах Alinity с "ICT модуль Калибраторы для сыворотки крови (Alinity с ICT Serum Calibrator Kit)"

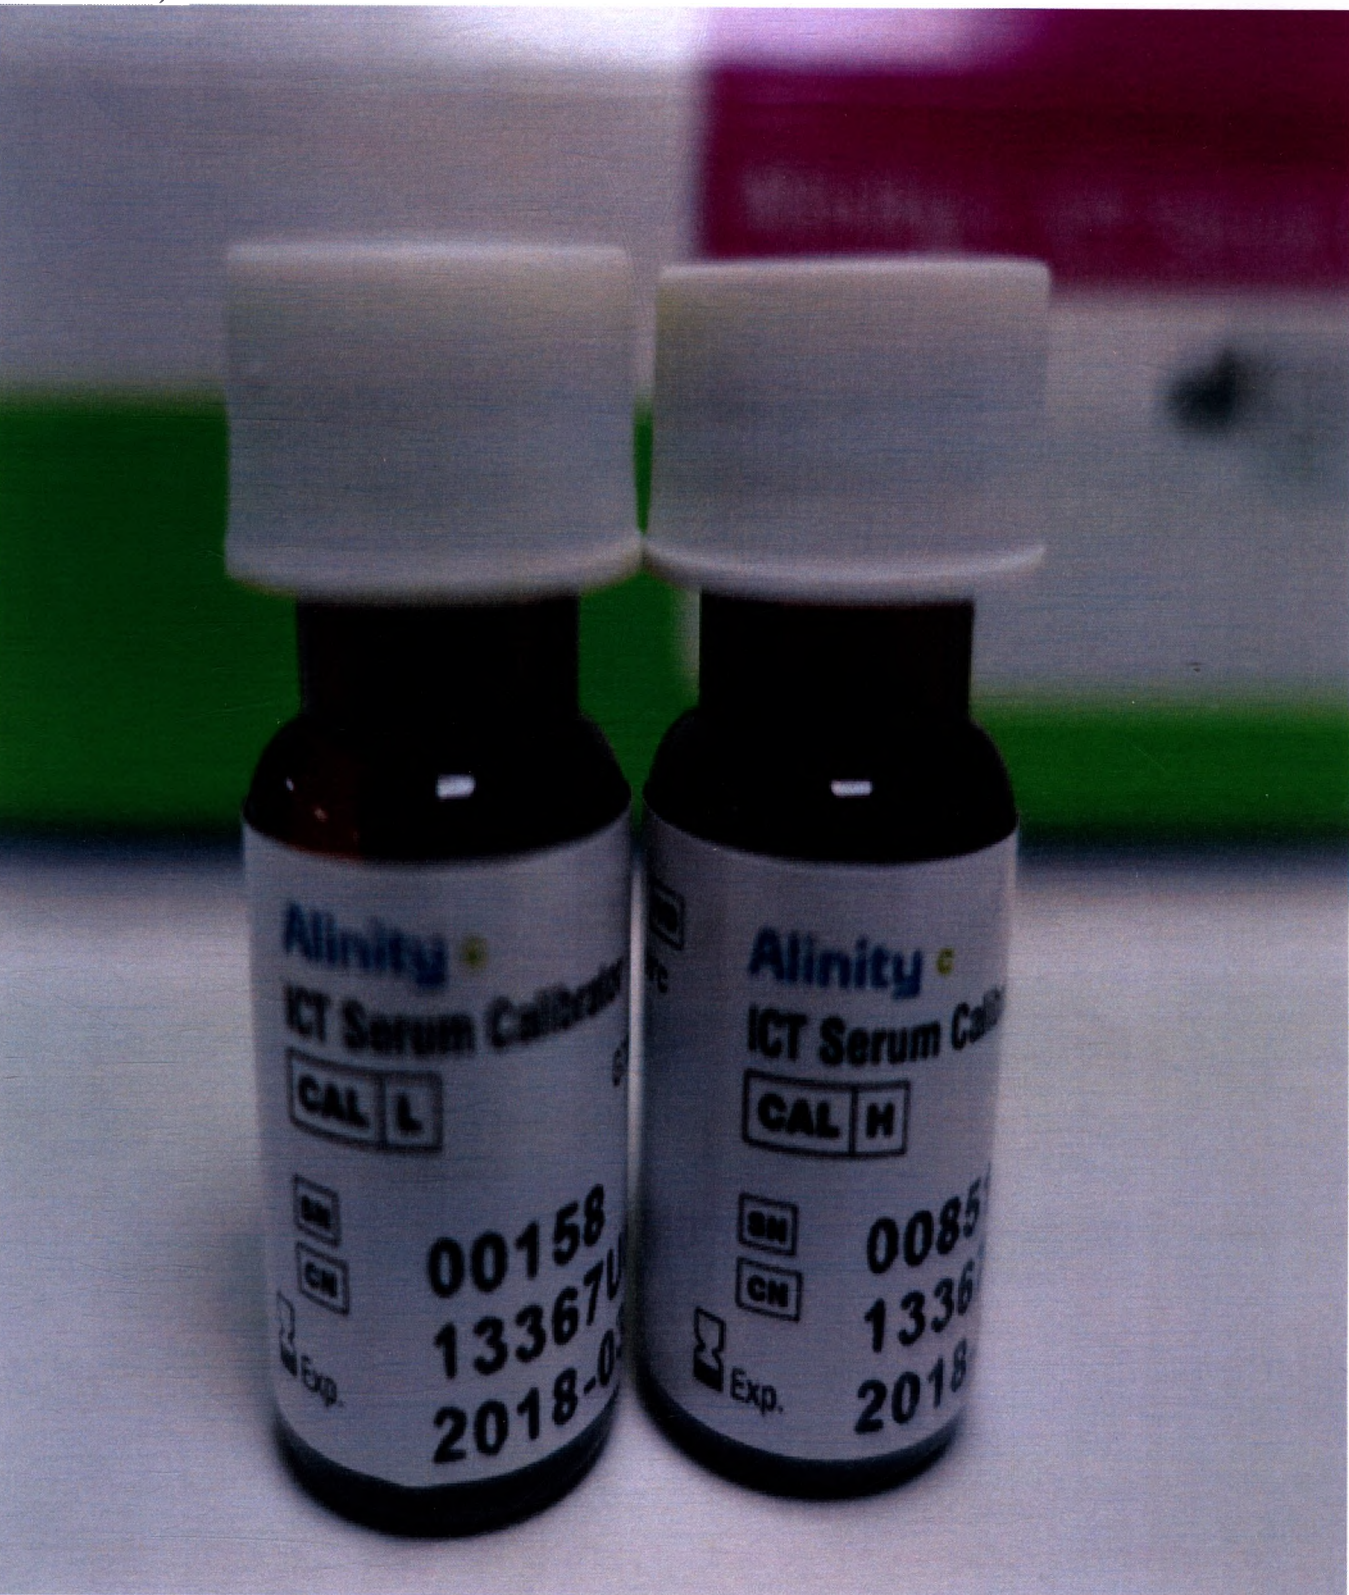

Всего прошито, пронумеровано  
и скреплено печатью

\_\_\_\_ листов

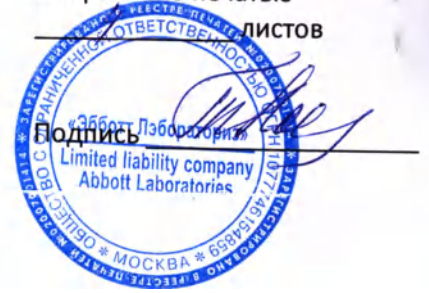

Макет маркировки на медицинское изделие для диагностики in vitro на  
русском языке

**Набор калибраторов для обеспечения правильности количественного  
определения электролитов в сыворотке крови человека  
потенциометрическим методом с помощью ICT- модуля на  
биохимических анализаторах Alinity с "ICT модуль Калибраторы для  
сыворотки крови (Alinity с ICT Serum Calibrator Kit)"**






ICT модуль Калибраторы для сыворотки  
крови (Alinity c ICT Serum Calibrator Kit)

08P69

2.9 мл

XXXXXX



CAL L

SN

CN

ABBOTT



Exp.



Alinity c

08P69

ICT Serum Calibrator 2.9 mL



CAL L

G70145R01

SN

CN

ABBOTT



Exp.




ICT модуль Калибраторы для мочи (Alinity c  
ICT Urine Calibrator Kit)

08P70

2.9 мл

XXXXXX



CAL H


SN

CN

ABBOTT



Exp.

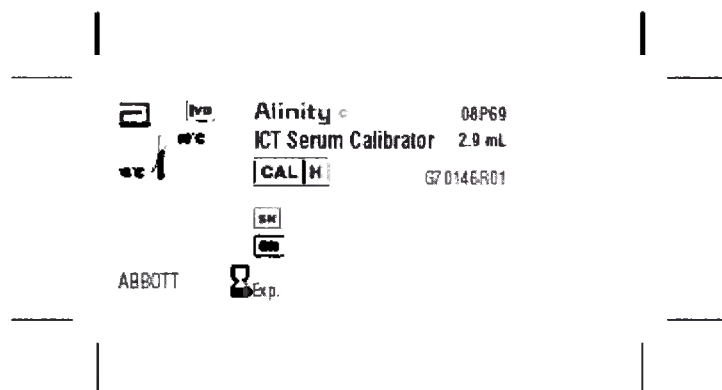

Сведения о стандартах, применяемых к этикетке на МИ:

| Стандарт                  | Наименование стандарта                                                                                                                                                                              |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ГОСТ Р ИСО 18113-1 – 2015 | Медицинские изделия для диагностики <i>in vitro</i> . Информация, предоставляемая изготовителем (маркировка). Часть 1. Термины, определения и общие требования.                                     |
| ГОСТ Р ИСО 18113-2 – 2015 | Медицинские изделия для диагностики <i>in vitro</i> – Информация, предоставляемая производителем (маркировка) – Часть 2: Реагенты для диагностики <i>in vitro</i> для профессионального применения. |
| ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014   | Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации. Часть 1. Основные требования.                                      |
| ГОСТ Р 51088-2013         | Медицинские изделия для диагностики <i>in vitro</i> . Реагенты, наборы реагентов, тест-системы, контрольные материалы, питательные среды. Требования к изделиям и поддерживающей документации.      |

Расшифровка символов представлена в инструкции.

Всего прошито, пронумеровано  
и скреплено печатью  
листов



Подпись  
Abbott Laboratories