



Катетеры аспирационные стерильные однократного применения, ТУ 9436-015-70440344-2016

в исполнении СН4 длина 53 см

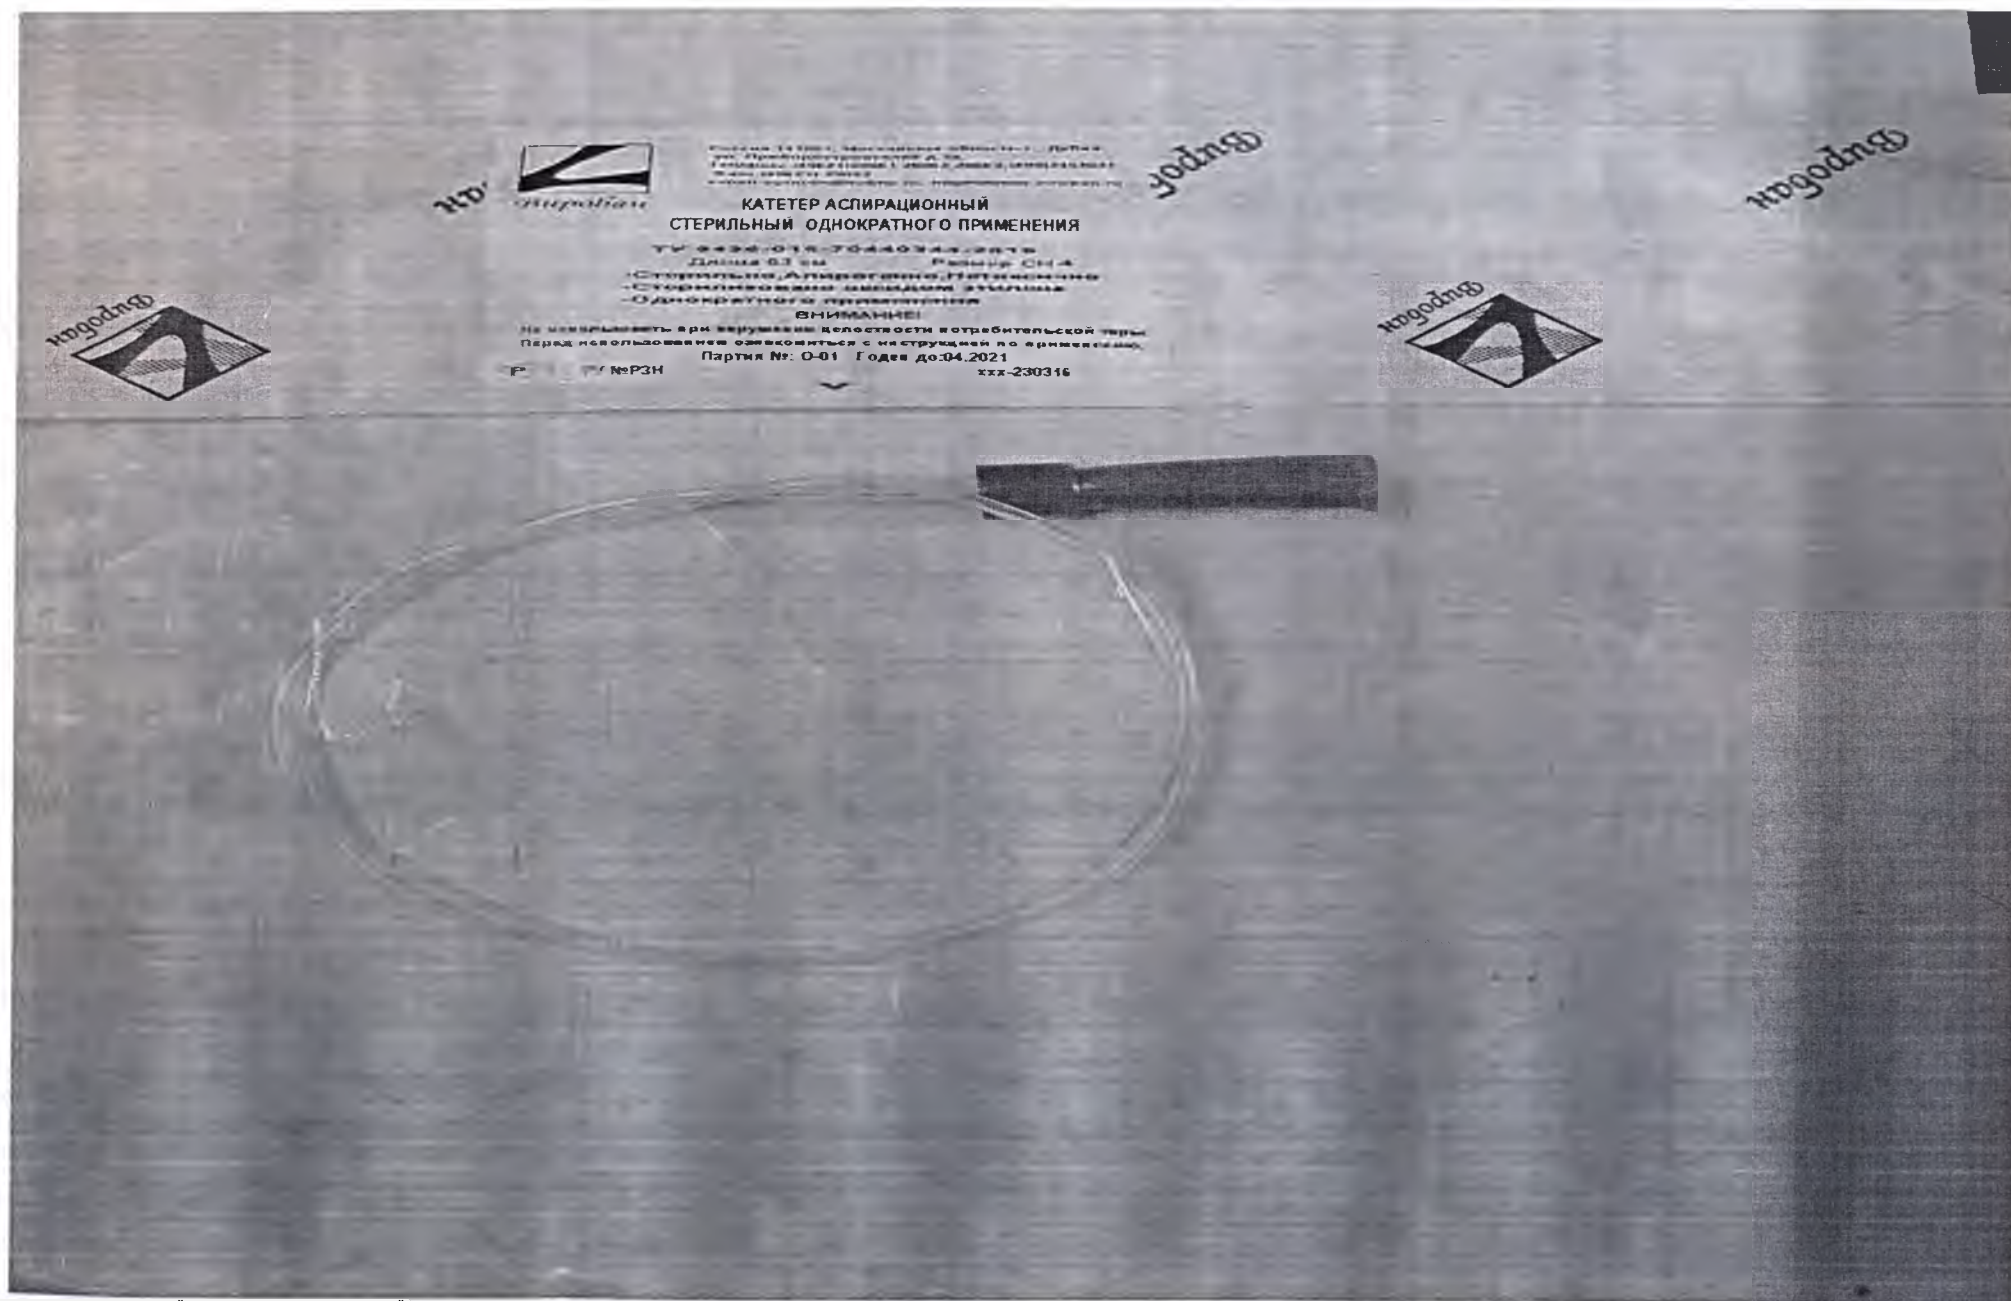



Viroban

Россия, 141981, Московская область, г. Дубна
уп. Приборостроителей д.3а,
Тел/факс: (4962) 112886 1, 28862, 28863, (495) 745 7031,
Факс: (49621) 29022
e-mail: opinion@dubna.ru, <http://www.viroban.ru>

**КАТЕТЕР АСПИРАЦИОННЫЙ
СТЕРИЛЬНЫЙ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ**

ТУ 9436-015-70440344-2016

Длина 53 см


Размер СН4

- Стерильно, Апирогенно, Нетоксично
- Стерилизовано оксидом этилена
- Однократного применения

ВНИМАНИЕ!

Не использовать при нарушении целостности потребительской тары.
Перед использованием ознакомиться с инструкцией по применению.

Партия №: О-01 Годен до: 04.2021



РУ №РЗН

xxx-230316






Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью ООО « Виробан»


_____ л.

Генеральный директор ООО « Виробан»

_____ В.В. Николаев

в исполнении СН5 длина 53 см

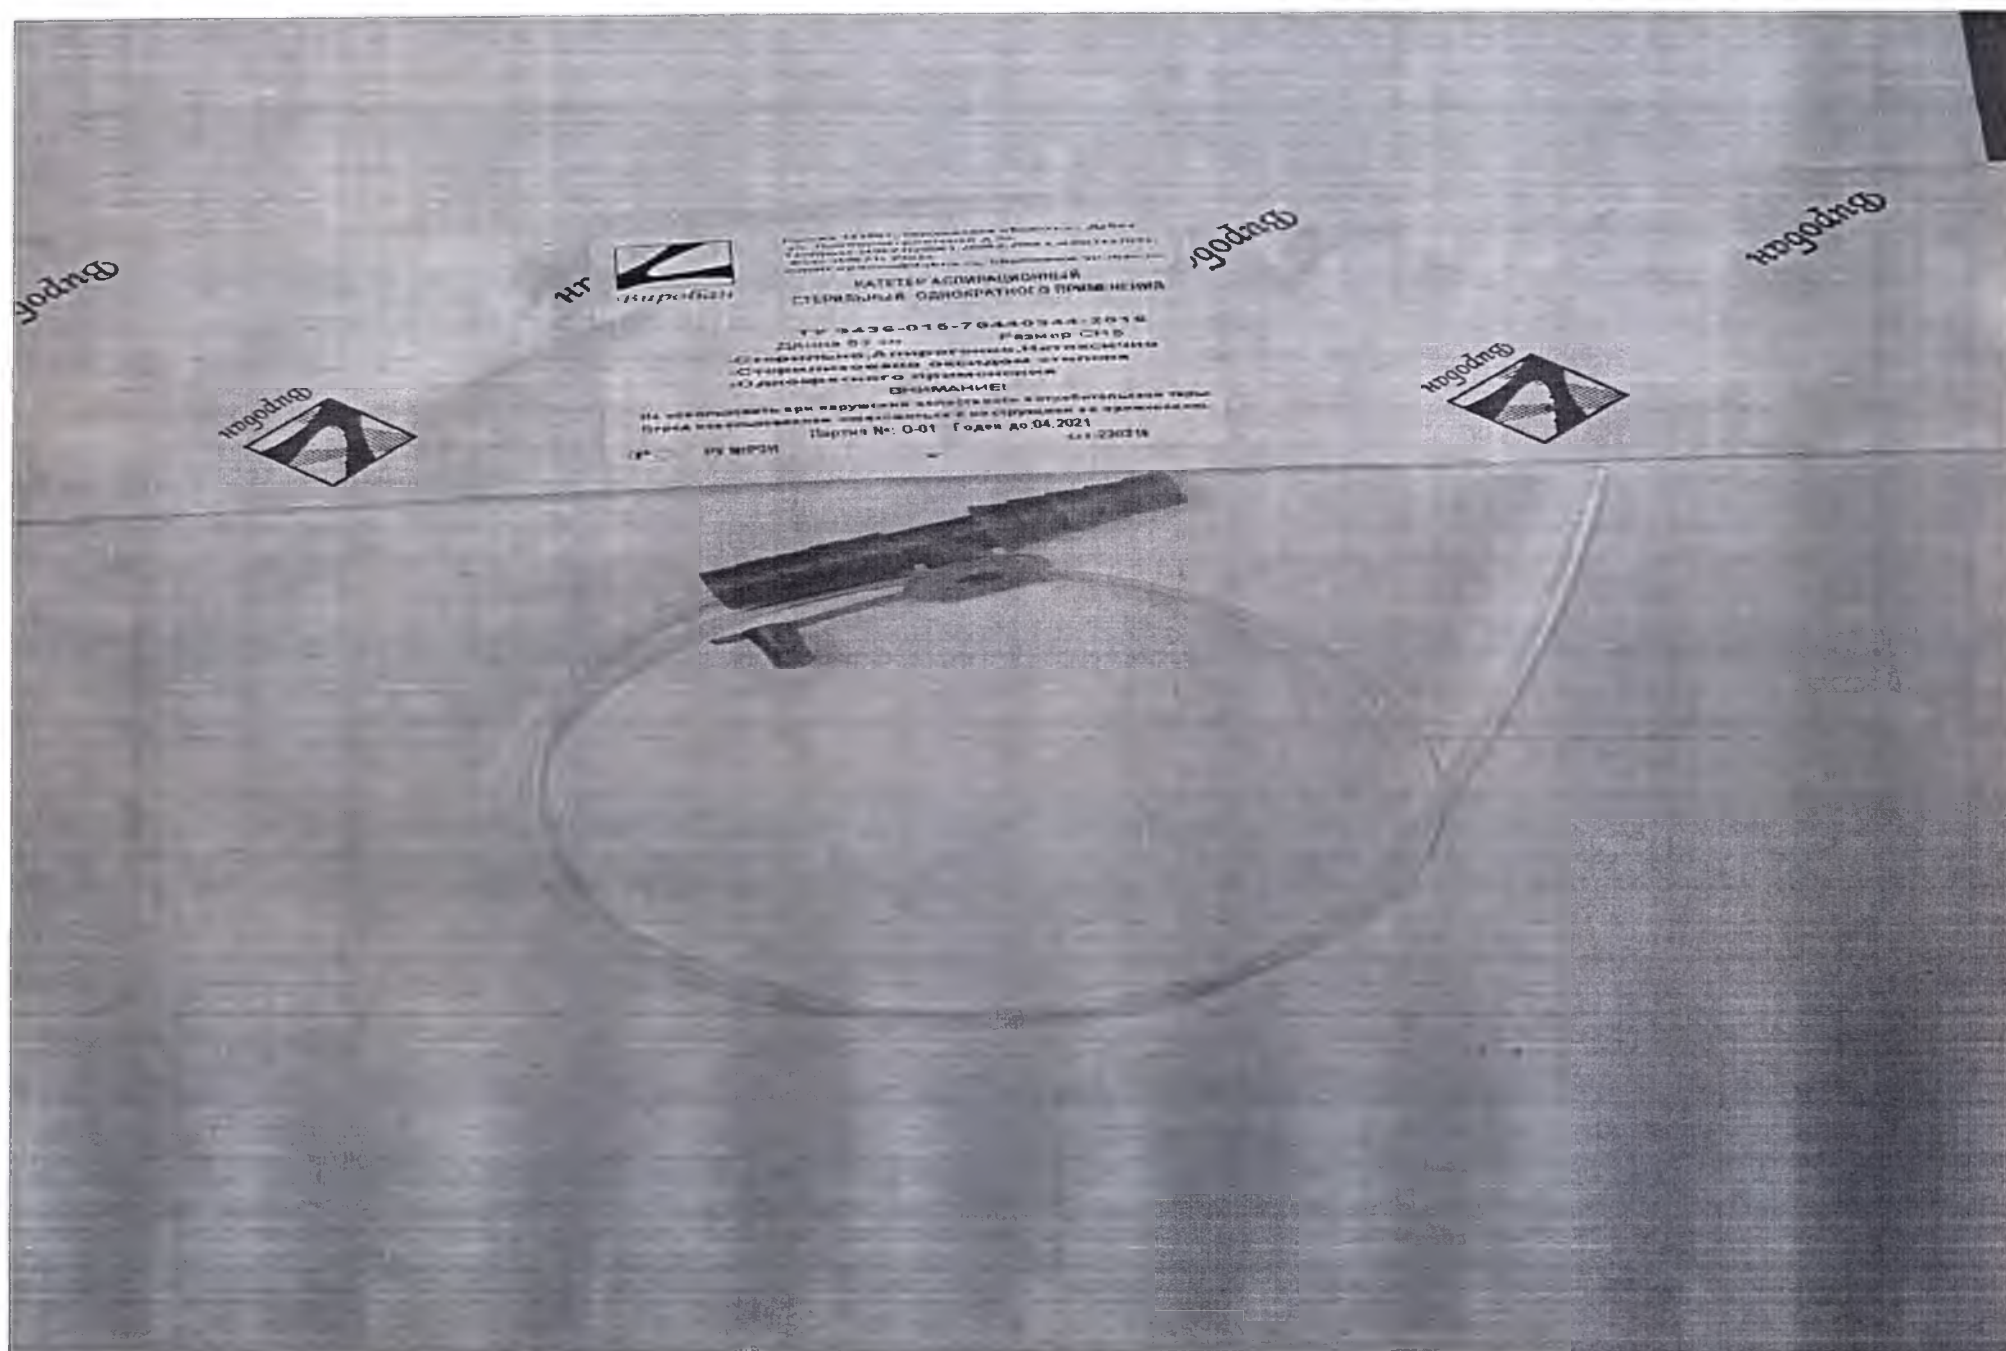

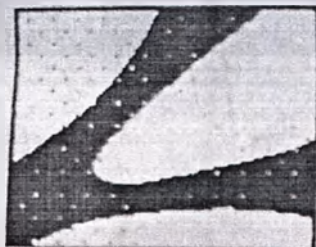

Виробан

Россия, 141981, Московская область, г. Дубна
ул. Приборостроителей д.3а,
Тел/факс (49621) 23861, 23862, 23863, (495) 7457031,
Факс (49621) 29022
e-mail: opinion@dubna.ru, <http://www.viroban.ru>

КАТЕТЕР АСПИРАЦИОННЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

ТУ 9436-015-70440344-2016

Длина 53 см

Размер CH5


- Стерильно, Апиrogenно, Нетоксично
- Стерилизовано оксидом этилена
- Однократного применения

ВНИМАНИЕ!

Не использовать при нарушении целостности потребительской тары
Перед использованием ознакомиться с инструкцией по применению.

Партия №: 0-01 Годен до: 04.2021

xxx-230316



РУ №РЗН




Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью ООО « Виробан»

В.В. Николаев л.

Генеральный директор ООО « Виробан»

В.В. Николаев

в исполнении СН6 длина 53 см

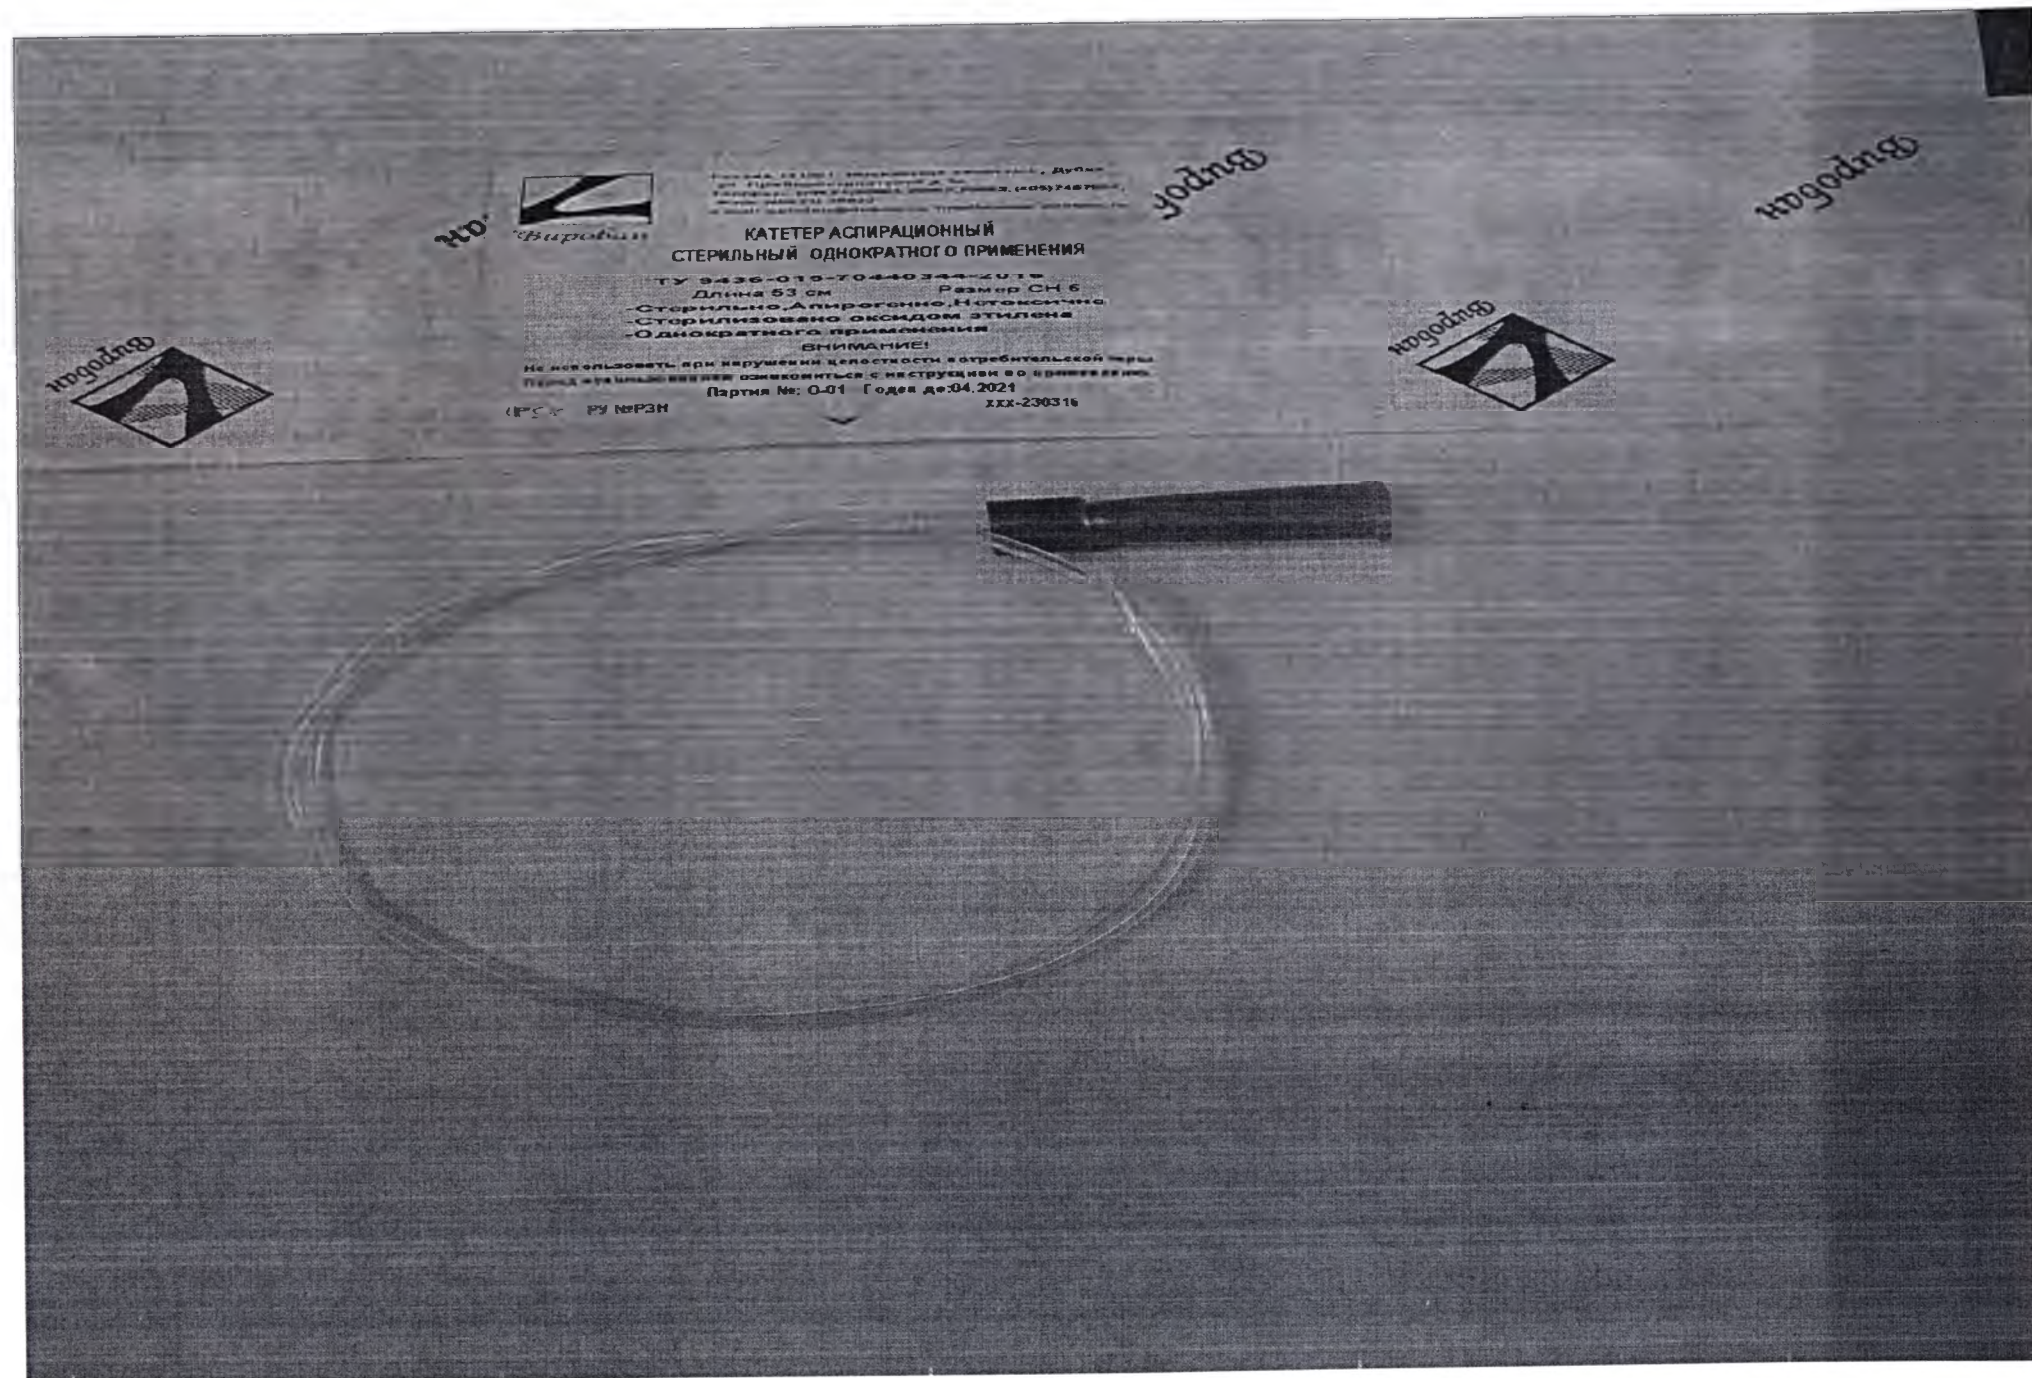



Виробан

Россия, 141981, Московская область, г., Дубна
ул. Приборостроителей д.3а,
Тел/факс: (49621) 2886 1, 2886 2, 2886 3, (495) 7457031;
Факс: (49621) 29022
e-mail: opinion@dubna.ru, <http://www.viroban.ru>

КАТЕТЕР АСПИРАЦИОННЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

ТУ 9436-015-70440344-2016

Длина 53 см


Размер СН 6

- Стерильно, Апиrogenно, Нетоксично
- Стерилизовано оксидом этилена
- Однократного применения

ВНИМАНИЕ!

Не использовать при нарушении целостности потребительской тары.
Перед использованием ознакомиться с инструкцией по применению.

Партия №: 0-01 Годен до: 04.2021



РУ №РЗН


xxx-230316

Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью ООО « Виробан»



_____. л.
Генеральный директор ООО « Виробан»
В.В. Николаев

в исполнении СН8 длина 53 см

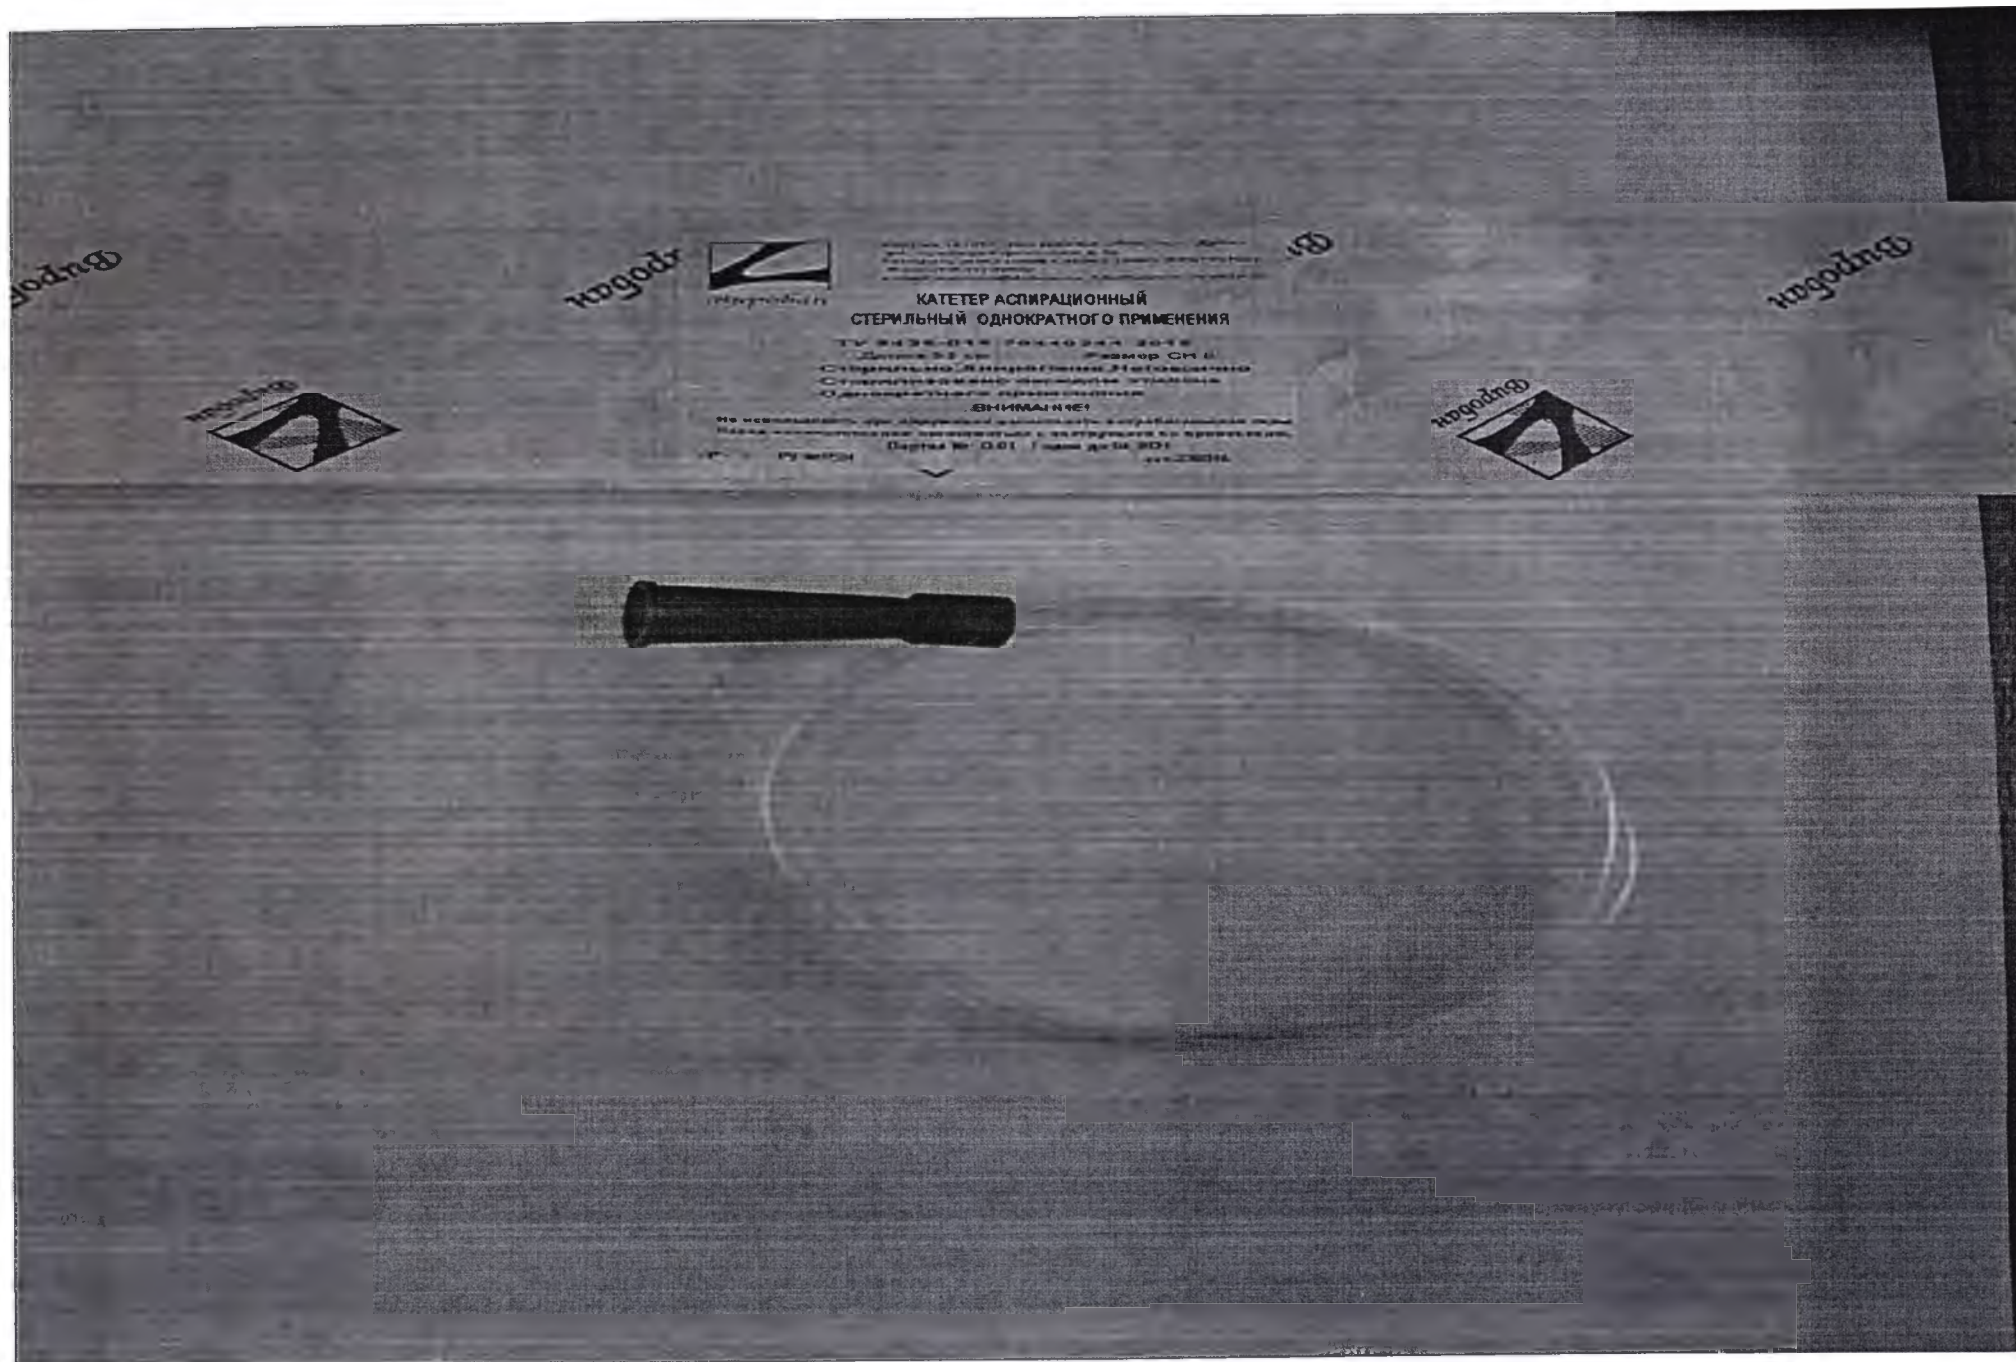



Виробан

Россия, 141981 Московская область, г. Дубна
ул. Приборостроителей д.3а,
Тел/факс (49621) 28861, 28862, 28863, (495) 7457031;
Факс (49621) 29022
e-mail: opinion@dubna.ru, <http://www.viroban.ru>

**КАТЕТЕР АСПИРАЦИОННЫЙ
СТЕРИЛЬНЫЙ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ**

ТУ 9436-015-70440344-2016


Длина 53 см Размер СН 8

- Стерильно, Апирогенно, Нетоксично**
- Стерилизовано оксидом этилена**
- Однократного применения**

ВНИМАНИЕ!

**Не использовать при нарушении целостности потребительской тары.
Перед использованием ознакомиться с инструкцией по применению.**

Партия №: О-01 Годен до: 04.2021



РУ №РЗН

xxx-230316




Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью ООО « Виробан»

л.

Генеральный директор ООО « Виробан»

В.В. Николаев

В исполнении СН10 длина 53 см

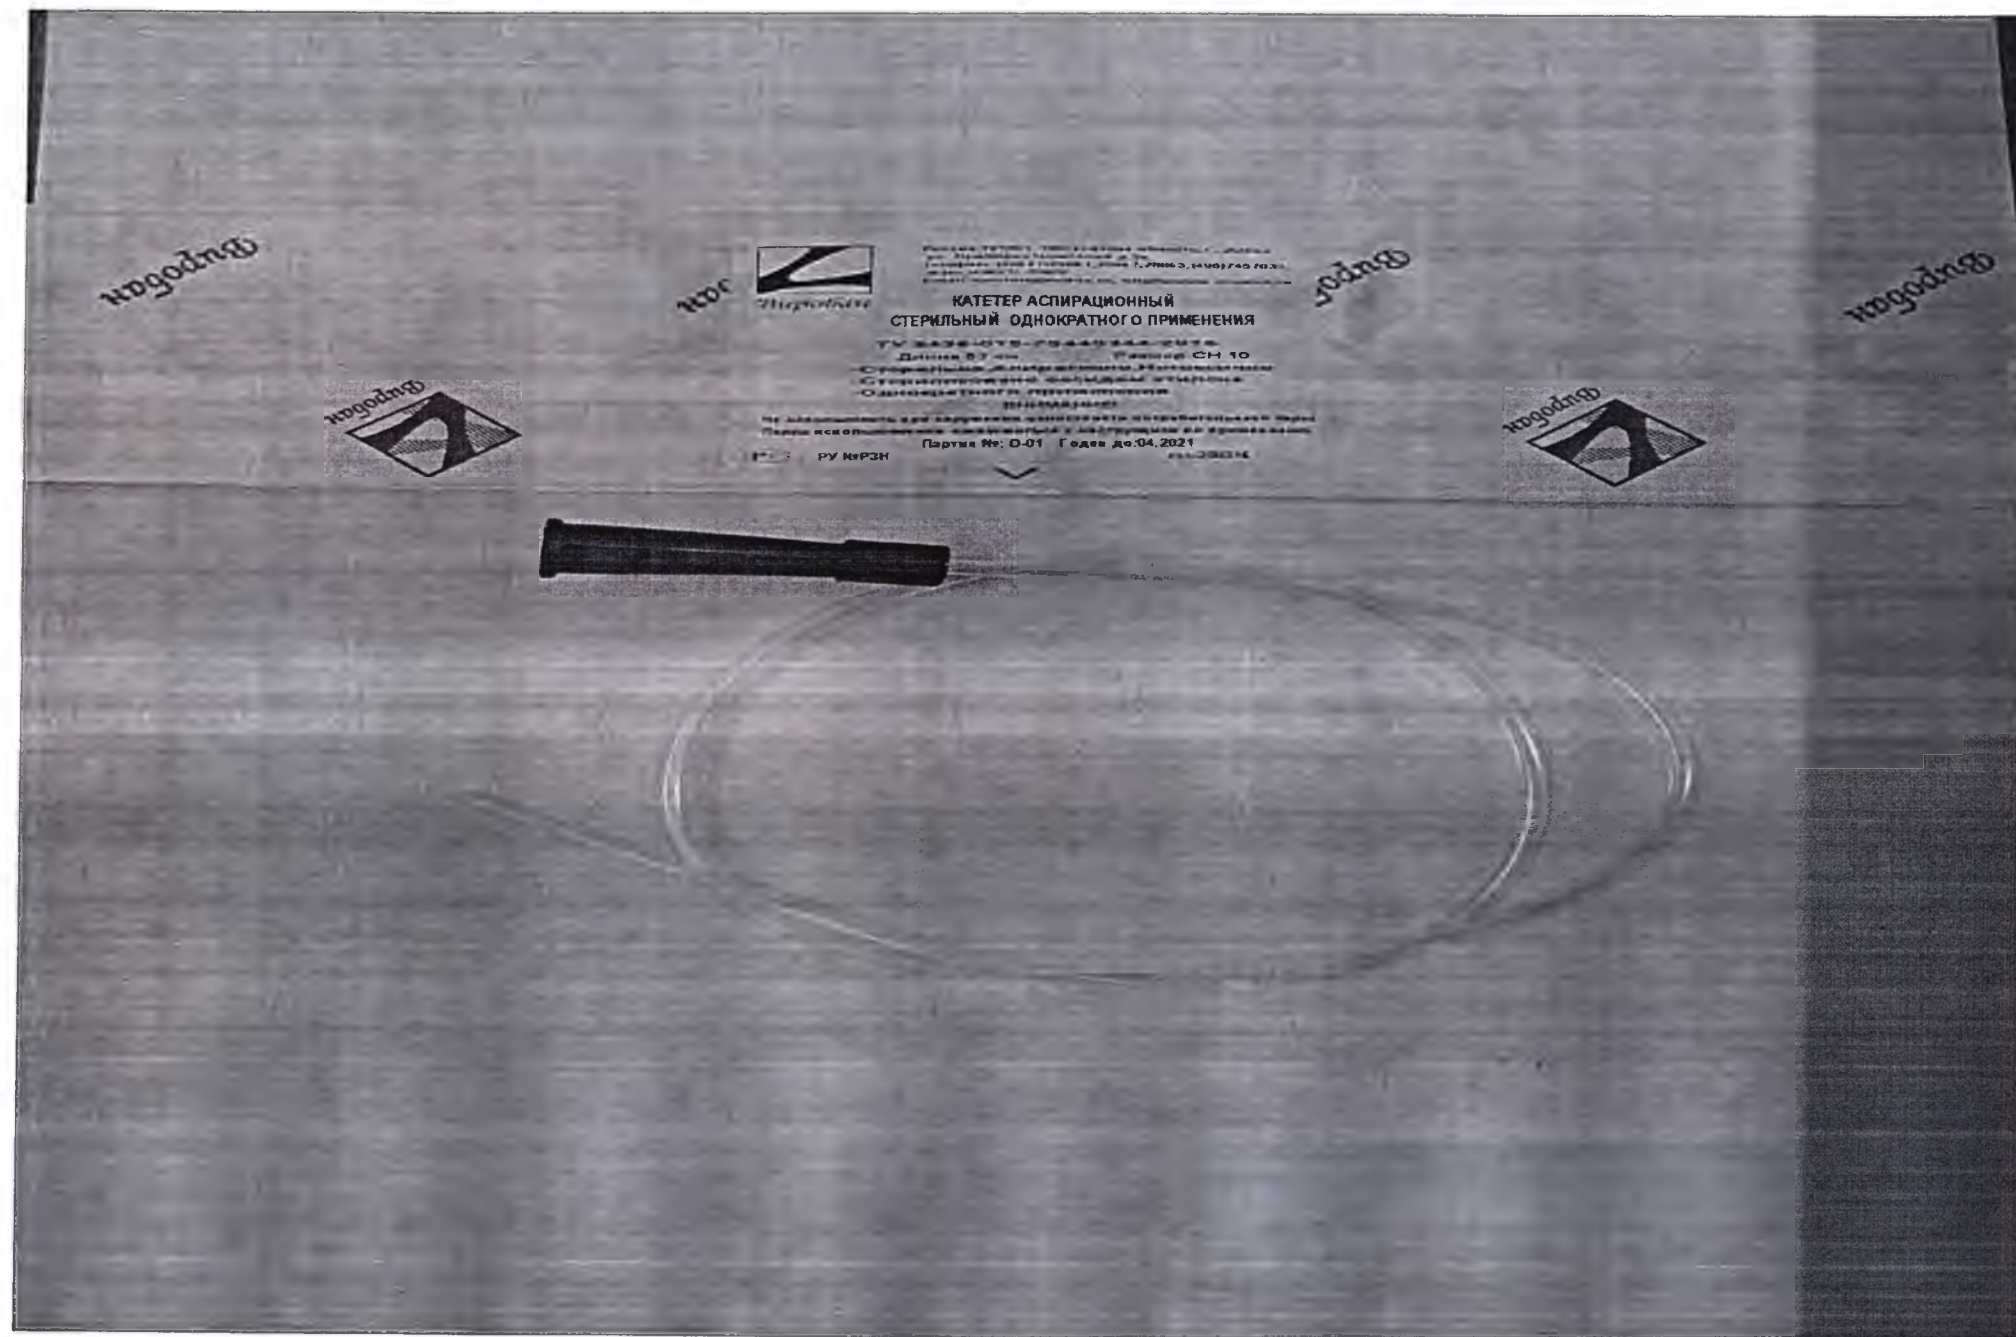

Маркировка потребительской тары Катетеры аспирационные стерильные однократного применения СН10 длина 53 см по ТУ 9436-015-70440344-2016



Виробан

Россия, 141981, Московская область г. Дубна
ул. Приборостроителей д.3а,
Тел/факс: (49621) 28861, 28862, 28863, (495) 7457031;
Факс: (49621) 29022
e-mail: opinion@dubna.ru, <http://www.viroban.ru>

**КАТЕТЕР АСПИРАЦИОННЫЙ
СТЕРИЛЬНЫЙ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ**

ТУ 9436-015-70440344-2016

Длина 53 см


Размер СН 10

- Стерильно, Апиrogenно, Нетоксично**
- Стерилизовано оксидом этилена**
- Однократного применения**

ВНИМАНИЕ!

Не использовать при нарушении целостности потребительской тары.
Перед использованием ознакомиться с инструкцией по применению.

Партия №: О-01 Годен до: 04.2021



РУ №РЗН

xxx-230316

Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью ООО « Виробан»


л.

Генеральный директор ООО « Виробан»

В.В. Николаев



В исполнении СН12 длина 53 см

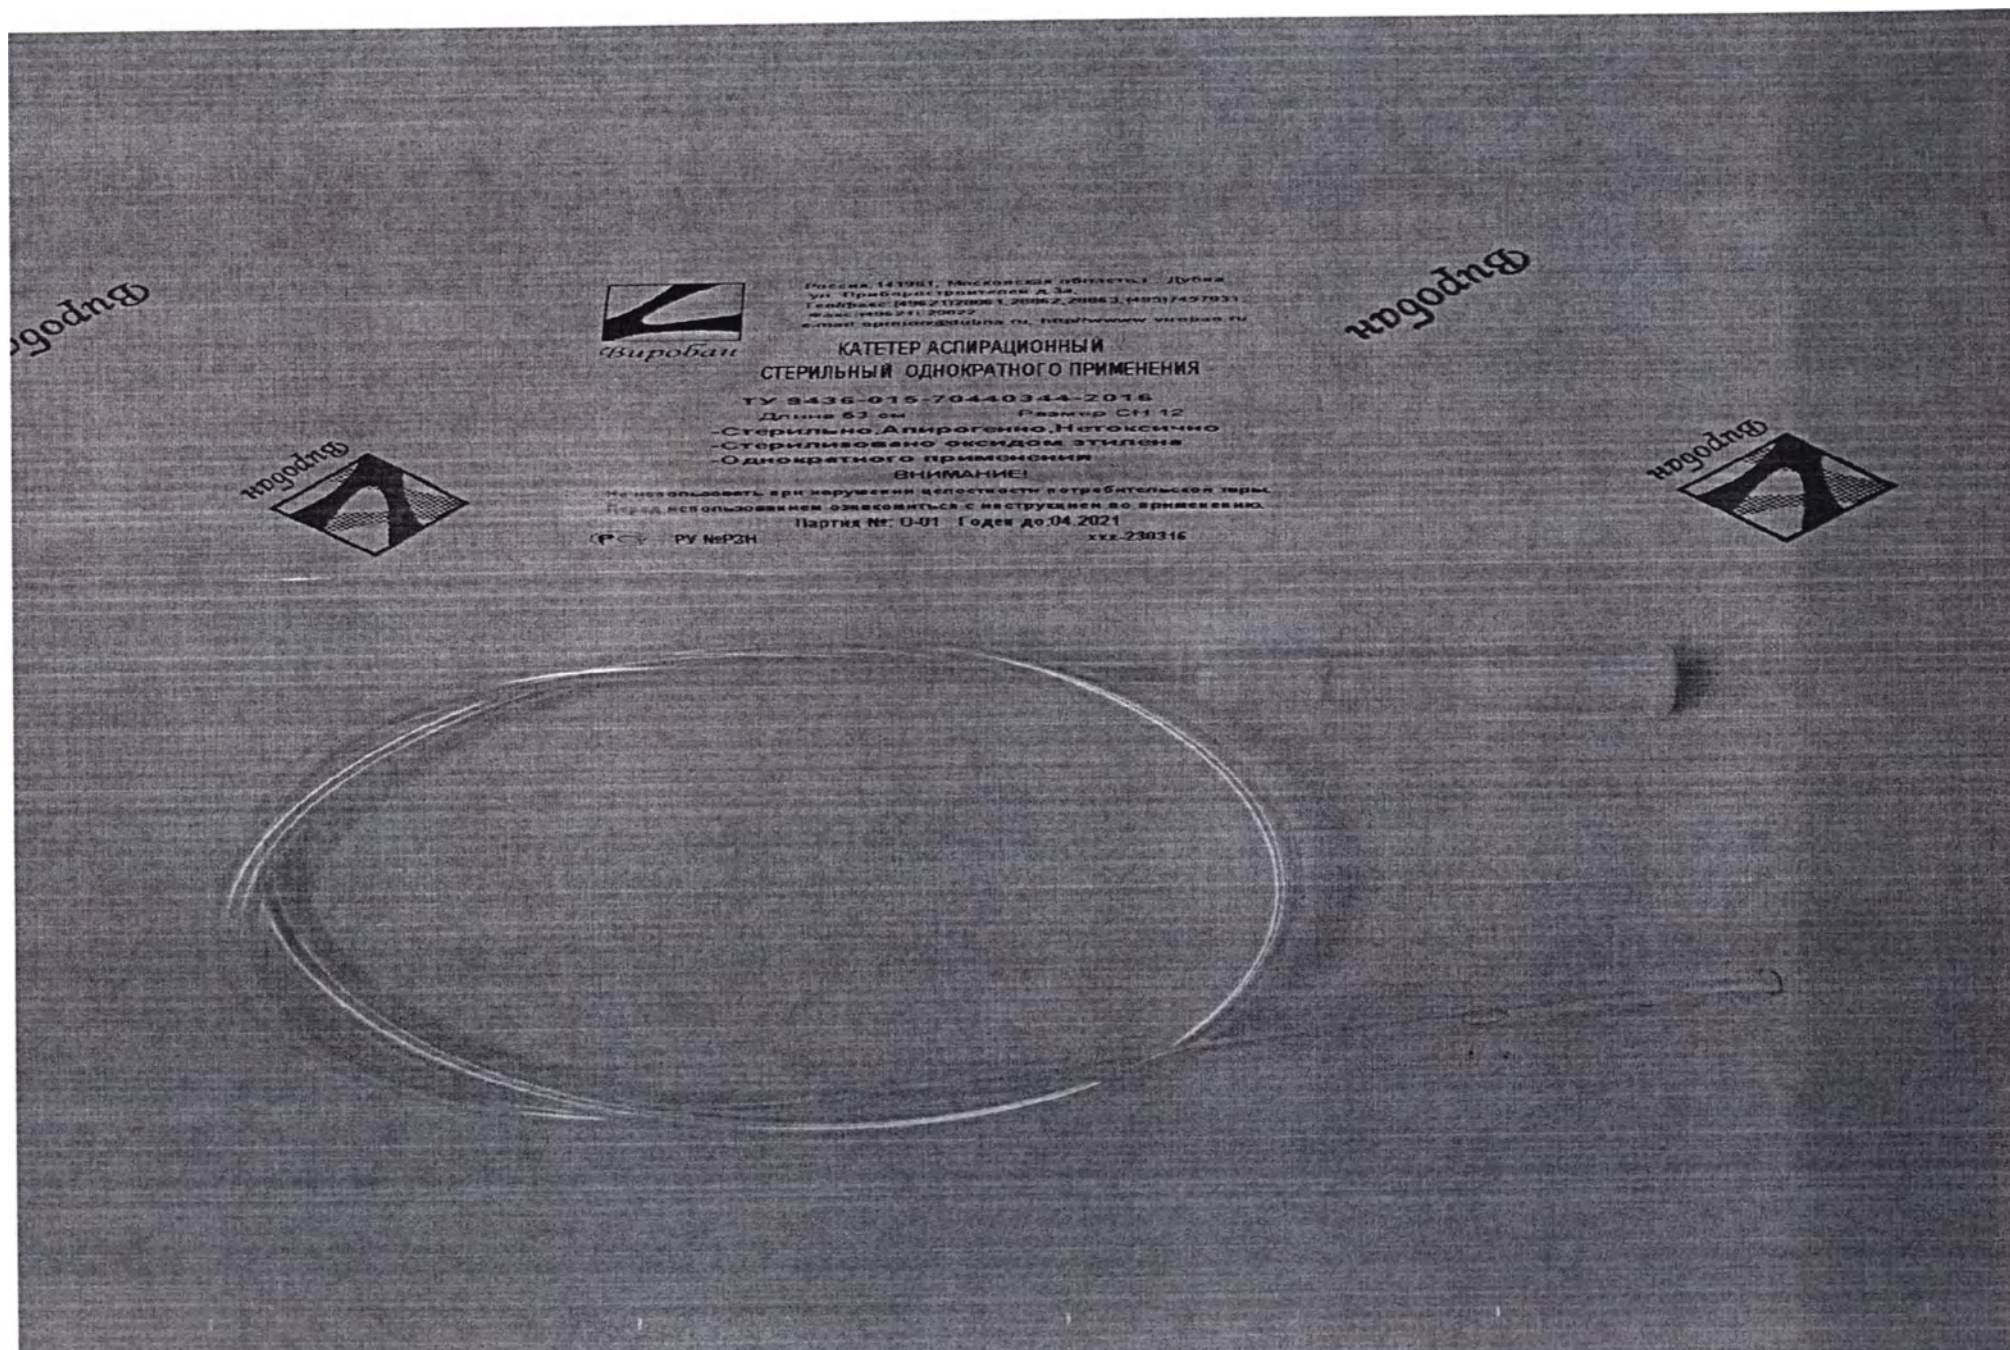

Маркировка потребительской тары Катетеры аспирационные стерильные однократного применения СН12 длина 53 см по ТУ 9436-015-70440344-2016



Виробан

Россия, 141981, Московская область, Дубна
ул. Приборостроителей д.34,
Тел/факс (49621) 2806 1, 2806 2, 2806 3, (495) 745 703 1,
Факс (49621) 73077
e-mail opinion@dubna.ru, <http://www.viroban.ru>

**КАТЕТЕР АСПИРАЦИОННЫЙ
СТЕРИЛЬНЫЙ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ**

ТУ 9436-015-70440344-2016

Длина 53 см

Размер СН 12

- Стерильно, Апиrogenно, Нетоксично
- Стерилизовано оксидом этилена
- Однократного применения

ВНИМАНИЕ!

Не использовать при нарушении целостности потребительской тары.
Перед использованием ознакомиться с инструкцией по применению.

Партия №: О-01 Годен до: 04.2021

Р РУ №РЗН

xxx-230316

Виробан



Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью ООО « Виробан»

_____ л.

Генеральный директор ООО « Виробан»

_____ В.В. Николаев

Маркировка потребительской тары Катетеры аспирационные стерильные однократного применения СН14 ,длина 53 см по ТУ 9436-015-70440344-2016



Виробан

Россия, 141981, Московская область, г. Дубна
ул. Приборостроителей д.3а,
Тел/факс (49621) 28861, 28862, 28863, (495) 7457031,
Факс (49621) 29022
e-mail: opinion@dubna.ru, <http://www.viroban.ru>

**КАТЕТЕР АСПИРАЦИОННЫЙ
СТЕРИЛЬНЫЙ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ**

ТУ 9436-015-70440344-2016

Длина 53 см


Размер СН 14

- Стерильно, Апирогенно, Нетоксично
- Стерилизовано оксидом этилена
- Однократного применения

ВНИМАНИЕ!


Не использовать при нарушении целостности потребительской тары.
Перед использованием ознакомиться с инструкцией по применению.

Партия №: О-01 Годен до: 04.2021



РУ №РЗН

xxx-230316

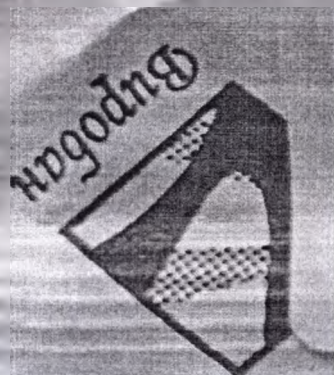

Маркировка потребительской тары Катетеры аспирационные стерильные однократного применения СН14 ,длина 53 см по ТУ 9436-015-70440344-2016



Виробан

Россия, 141981, Московская область, г. Дубна
ул. Приборостроителей д. 3а,
Тел/факс (4962) 288661, 288662, 288663, (495) 745/031,
Факс (49621) 29022
e-mail: opinion@viroban.ru, <http://www.viroban.ru>

КАТЕТЕР АСПИРАЦИОННЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

ТУ 9436-015-70440344-2016

Длина 53 см


Размер СН 14

- Стерильно, Апирогенно, Нетоксично
- Стерилизовано оксидом этилена
- Однократного применения

ВНИМАНИЕ!

Не использовать при нарушении целостности потребительской тары.
Перед использованием ознакомиться с инструкцией по применению.

Партия №: 0-01 Годен до: 04.2021



РУ №РЗН

xxx-230316

нагодн




Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью ООО « Виробан»

л.

Генеральный директор ООО « Виробан»

В.В. Николаев

В исполнении СН16 длина 53 см

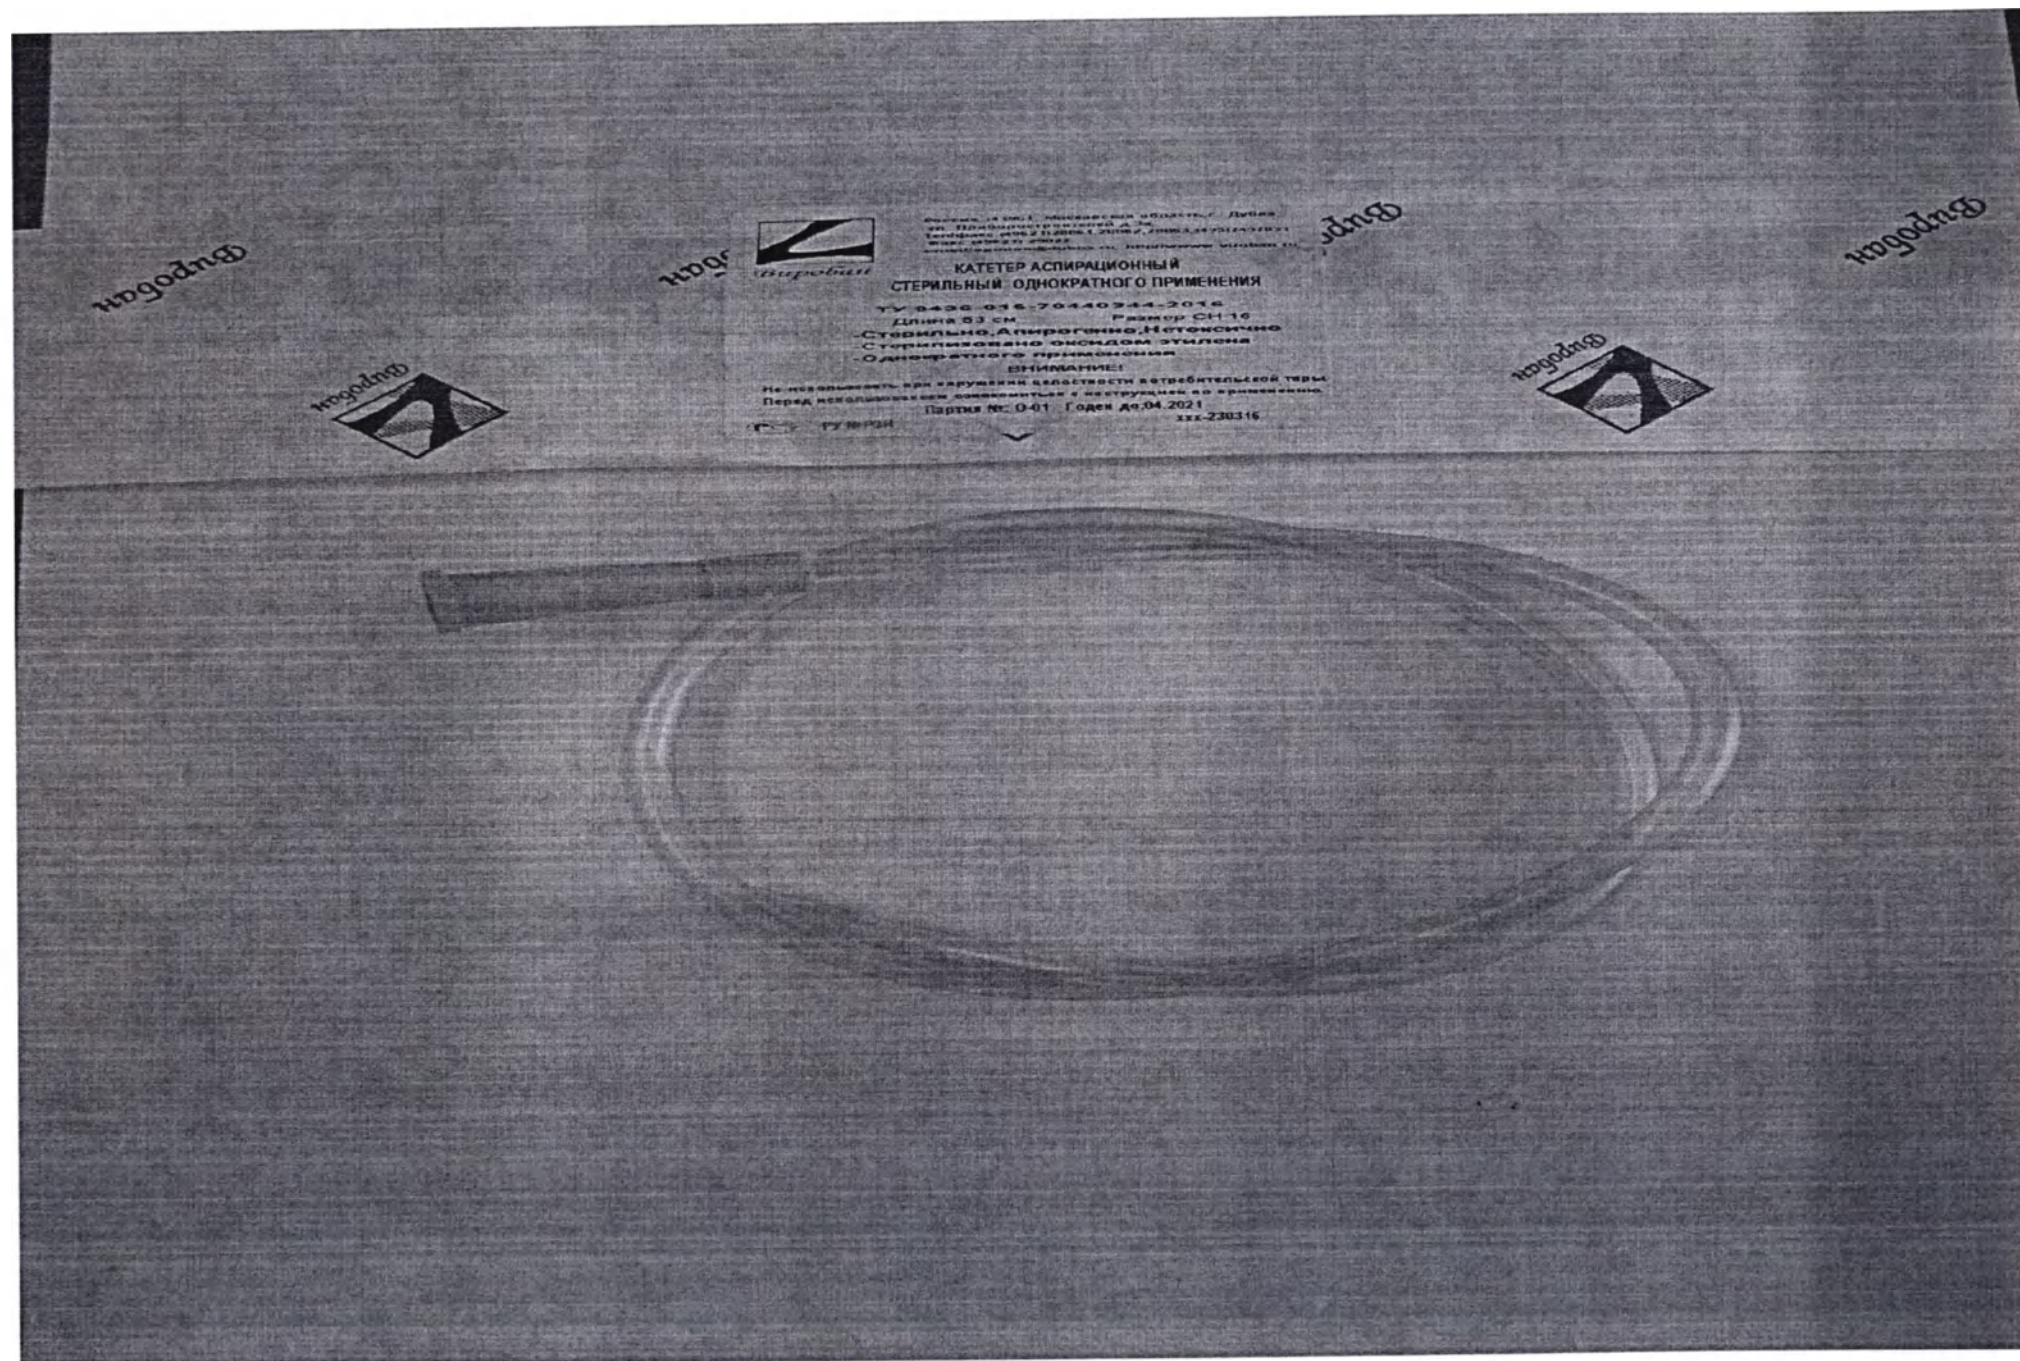

Маркировка потребительской тары Катетеры аспирационные стерильные однократного применения СН16 ,длина 53 см по ТУ 9436-015-70440344-2016



Виробан

Россия, 141981, Московская область, г. Дубна
ул. Приборостроителей д 3а,
Тел/факс (49621) 2886 1, 2886 2, 2886 3, (495) 745 7031.
Факс (49621) 29022
e-mail: opinion@dubna.ru, <http://www.viroban.ru>

**КАТЕТЕР АСПИРАЦИОННЫЙ
СТЕРИЛЬНЫЙ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
с вакуумконтролем**

ТУ 9436-015-70440344-2016

Длина 53 см

Размер СН 16

Стерильно, Апирогенно, Нетоксично

Стерилизовано оксидом этилена

Однократного применения


ВНИМАНИЕ!

**Не использовать при нарушении целостности потребительской тары.
Перед использованием ознакомиться с инструкцией по применению.**

Партия №: О-01 Годен до: 04.2021

Р РУ №РЗН

xxx-220316

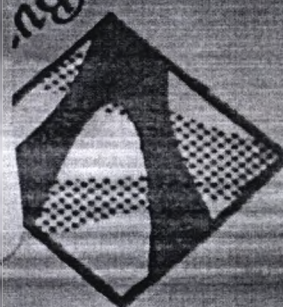

Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью ООО « Виробан»


л.

Генеральный директор ООО « Виробан»

В.В. Николаев



В исполнении СН18 длина 53 см

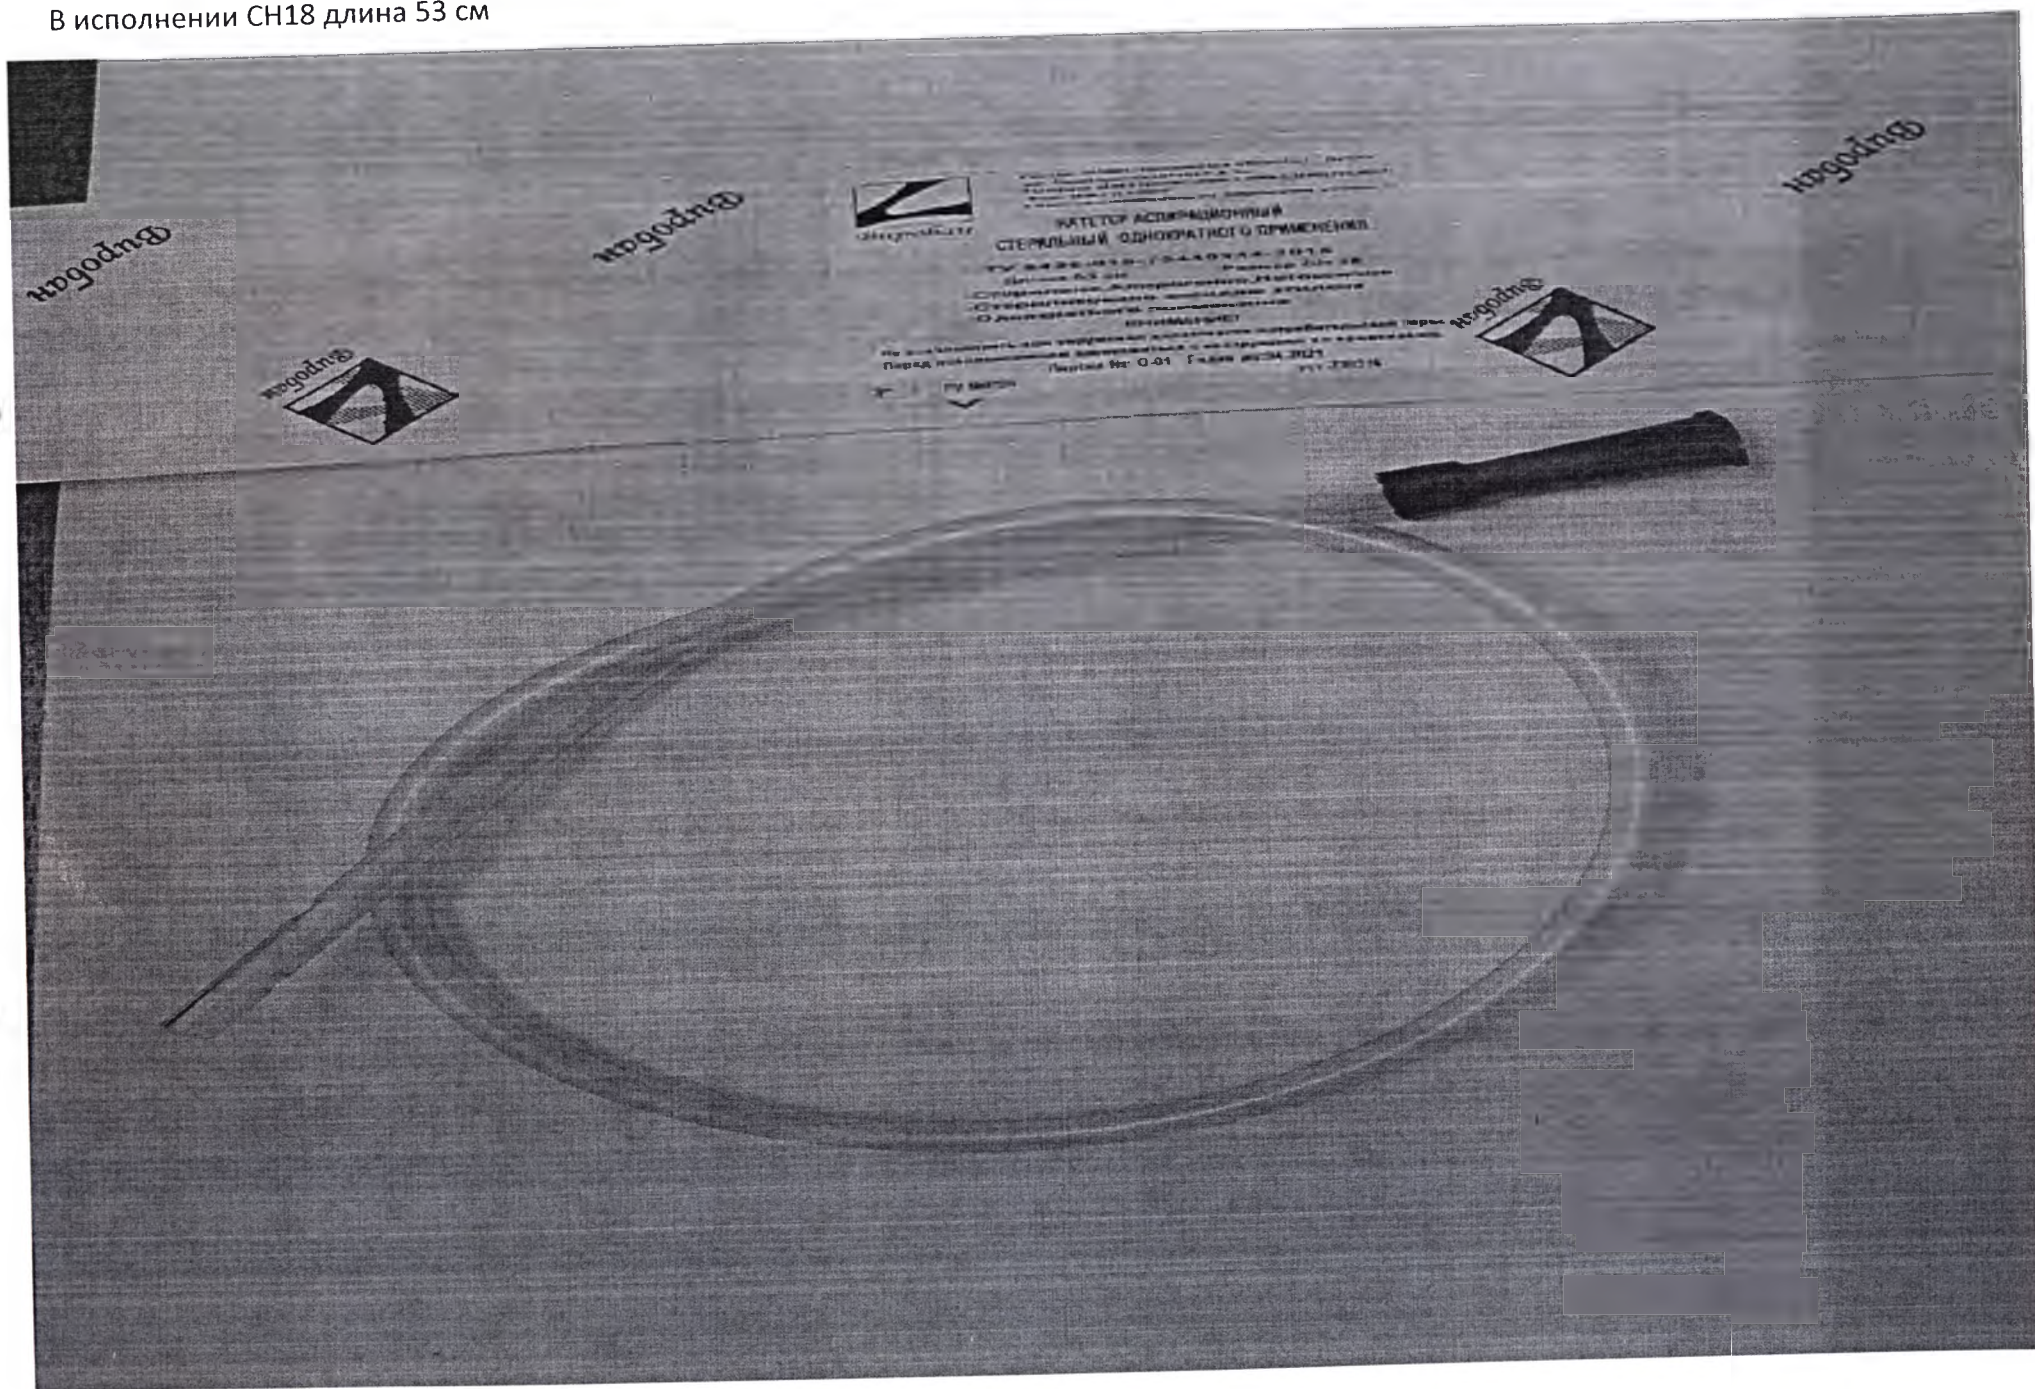



Виробан

Россия, 141981, Московская область, г. Дубна
ул. Приборостроителей д 3а,
Тел/факс: (49621) 28861, 28862, 28863, (495) 7457031,
факс (49621) 29022
e-mail: opinion@dubna.ru, <http://www.viroban.ru>

КАТЕТЕР АСПИРАЦИОННЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

ТУ 9436-015-70440344-2016

Длина 53 см


Размер СН 18

- Стерильно, Апирогенно, Нетоксично
- Стерилизовано оксидом этилена
- Однократного применения

ВНИМАНИЕ!

Не использовать при нарушении целостности потребительской тары.
Перед использованием ознакомиться с инструкцией по применению.

Партия №: 0-01 Годен до: 04.2021



РУ №РЗН

xxx-230316






Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью ООО « Виробан»

л.

Генеральный директор ООО « Виробан»

В.В. Николаев

В исполнении СН20 длина 53 см

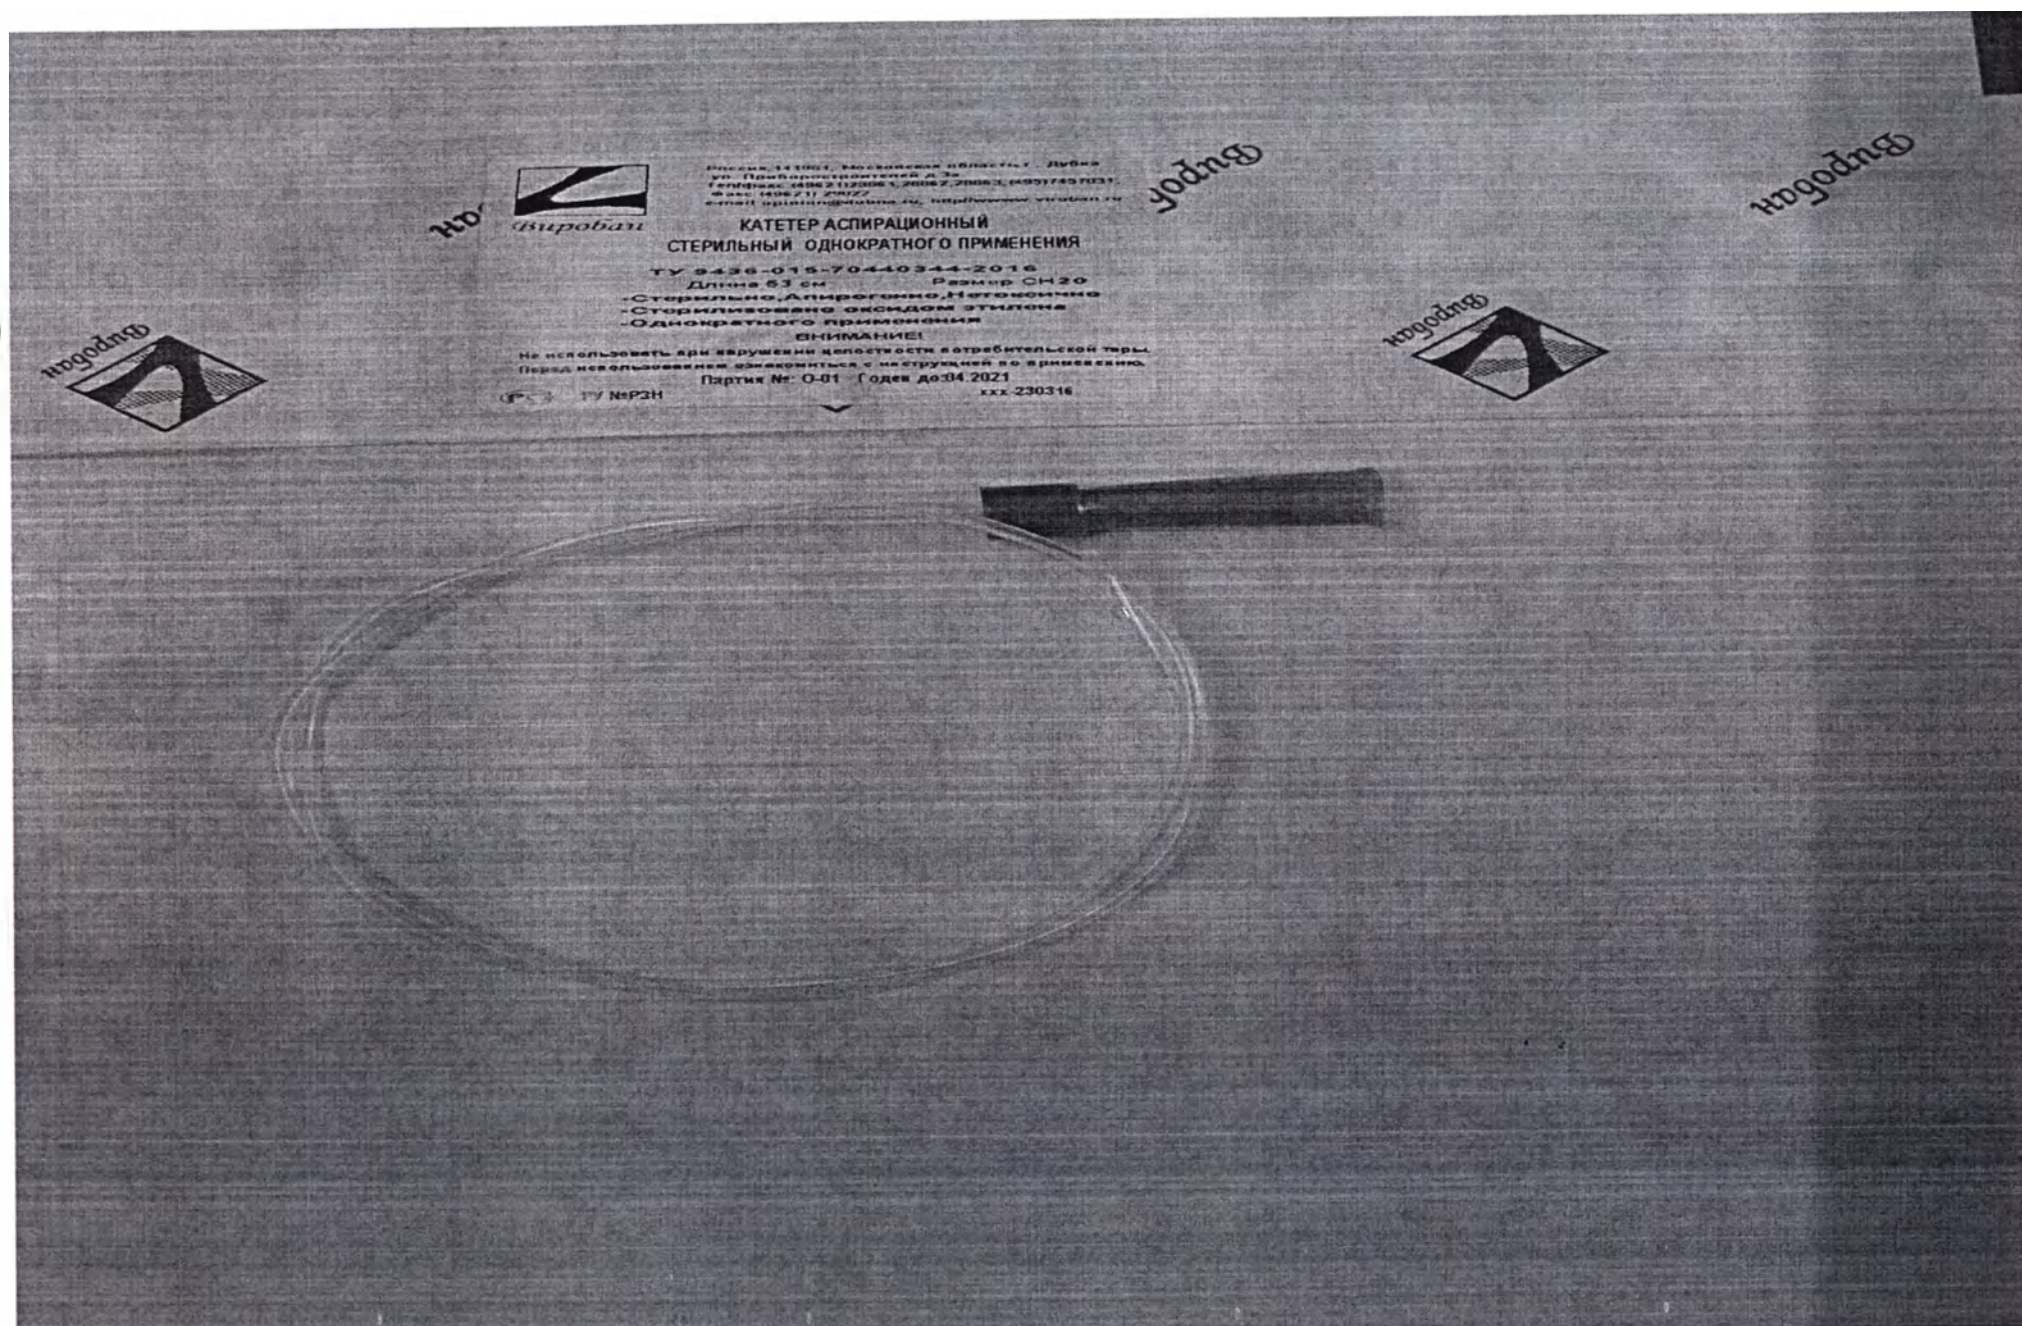

Виробан



Виробан

Россия, 141381, Московская область, г. Дубна
ул. Придворостроительная д. 3а,
Тел/факс: (49621) 288661, 288662, 288663 (49621) 457031,
Факс: (49621) 29022
e-mail: orpinom@dubna.ru, <http://www.viroban.ru>

Виробан

**КАТЕТЕР АСПИРАЦИОННЫЙ
СТЕРИЛЬНЫЙ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ**

ТУ 9436-015-70440344-2016

Длина 53 см

Размер СН 20

- Стерильно, Апиrogenно, Нетоксично
- Стерилизовано оксидом этилена
- Однократного применения

ВНИМАНИЕ!

Не использовать при нарушении целостности потребительской тары
Перед использованием ознакомиться с инструкцией по применению.

Партия №: О-01 Годен до: 04.2021

РУ №РЗН

xxx-230316



Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью ООО « Виробан»


л.

Генеральный директор ООО « Виробан»


В.В. Николаев



В исполнении СН22 длина 53 см

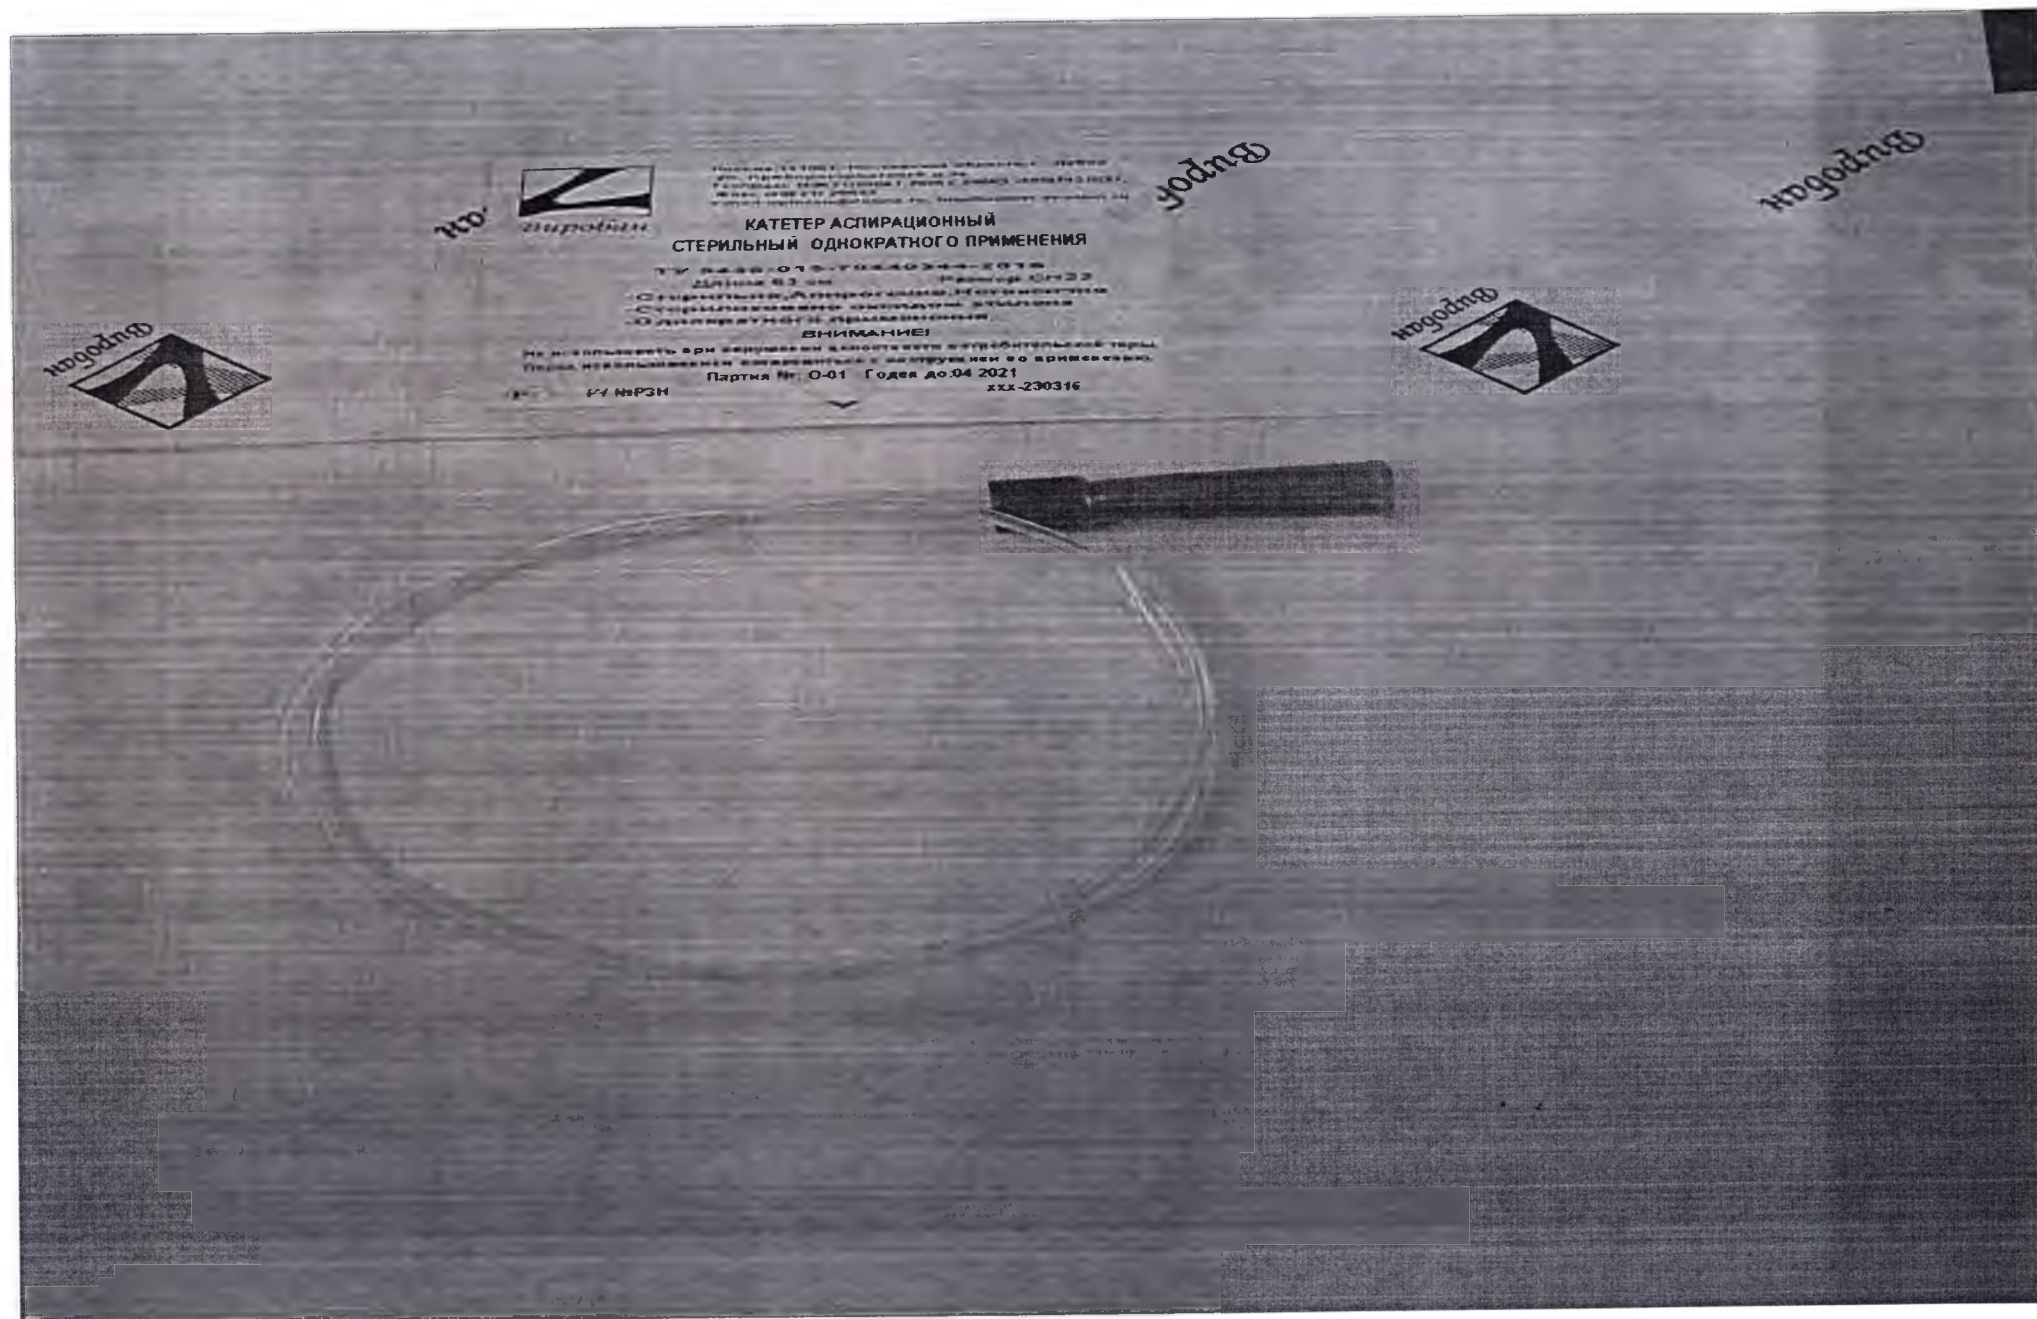

Маркировка потребительской тары Катетеры аспирационные стерильные однократного применения СН22 ,длина 53 см по ТУ 9436-015-70440344-2016



Виробан

Россия, 141981, Московская область, г. Дубна
ул. Приборостроителей д.34
Тел/факс: (4962) 112866 1, 20862 23063, (4962) 7457031
Факс: (496211) 29022
e-mail: opinion@dubna.ru, <http://www.viroban.ru>

**КАТЕТЕР АСПИРАЦИОННЫЙ
СТЕРИЛЬНЫЙ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ**

ТУ 9436-015-70440344-2016

Длина 53 см

Размер СН 22

- Стерильно, Апирогенно, Нетоксично
- Стерилизовано оксидом этилена
- Однократного применения

ВНИМАНИЕ!

Не использовать при нарушении целостности потребительской тары
Перед использованием ознакомиться с инструкцией по применению.

Партия №: О-01 Годен до: 04.2021

РУ №РЗН

xxx-230316




Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью ООО « Виробан»

21.08.2017 л.

Генеральный директор ООО « Виробан»

В.В. Николаев

В исполнении СН24 длина 53 см

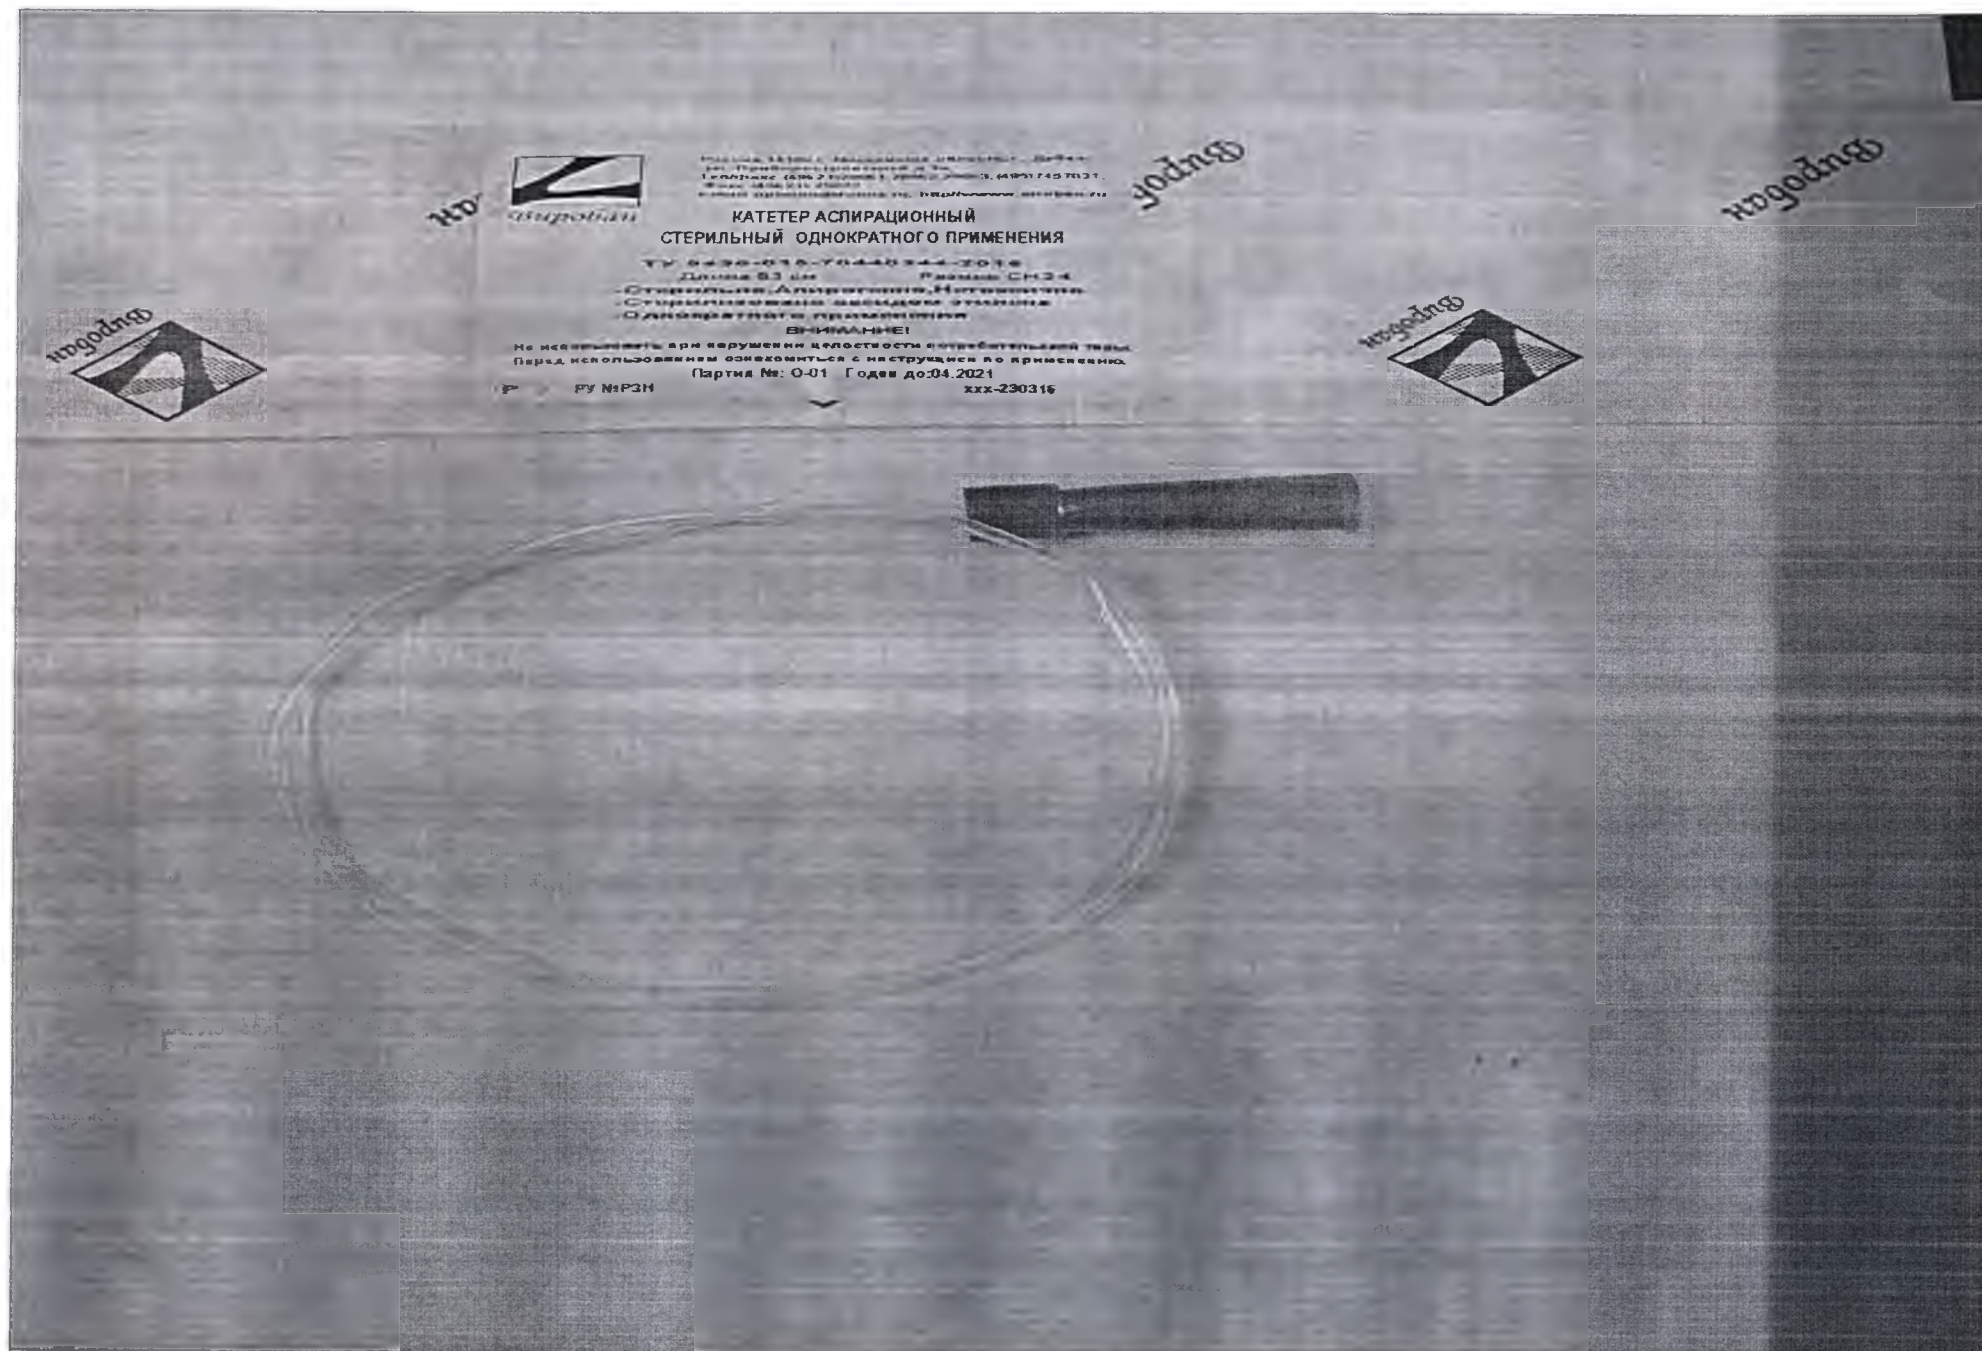



Виробан

Россия, 141981, Московская область г. Дубна
ул. Приборостроителей д.3а,
Тел/факс: (496 21) 2886 1, 2886 2, 2886 3, (495) 745 7031;
Факс: (496 21) 29022
e-mail: opinion@dubna.ru, <http://www.viroban.ru>

**КАТЕТЕР АСПИРАЦИОННЫЙ
СТЕРИЛЬНЫЙ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ**

ТУ 9436-015-70440344-2016

Длина 53 см

Размер СН 24

- Стерильно, Апирогенно, Нетоксично
- Стерилизовано оксидом этилена
- Однократного применения

ВНИМАНИЕ!

Не использовать при нарушении целостности потребительской тары.
Перед использованием ознакомиться с инструкцией по применению.

Партия №: О-01 Годен до: 04.2021



РУ №РЗН

XXX-230316




Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью ООО « Виробан»

21.08.2017 л.

Генеральный директор ООО « Виробан»

В.В. Николаев

В исполнении СН4 длина 60 см

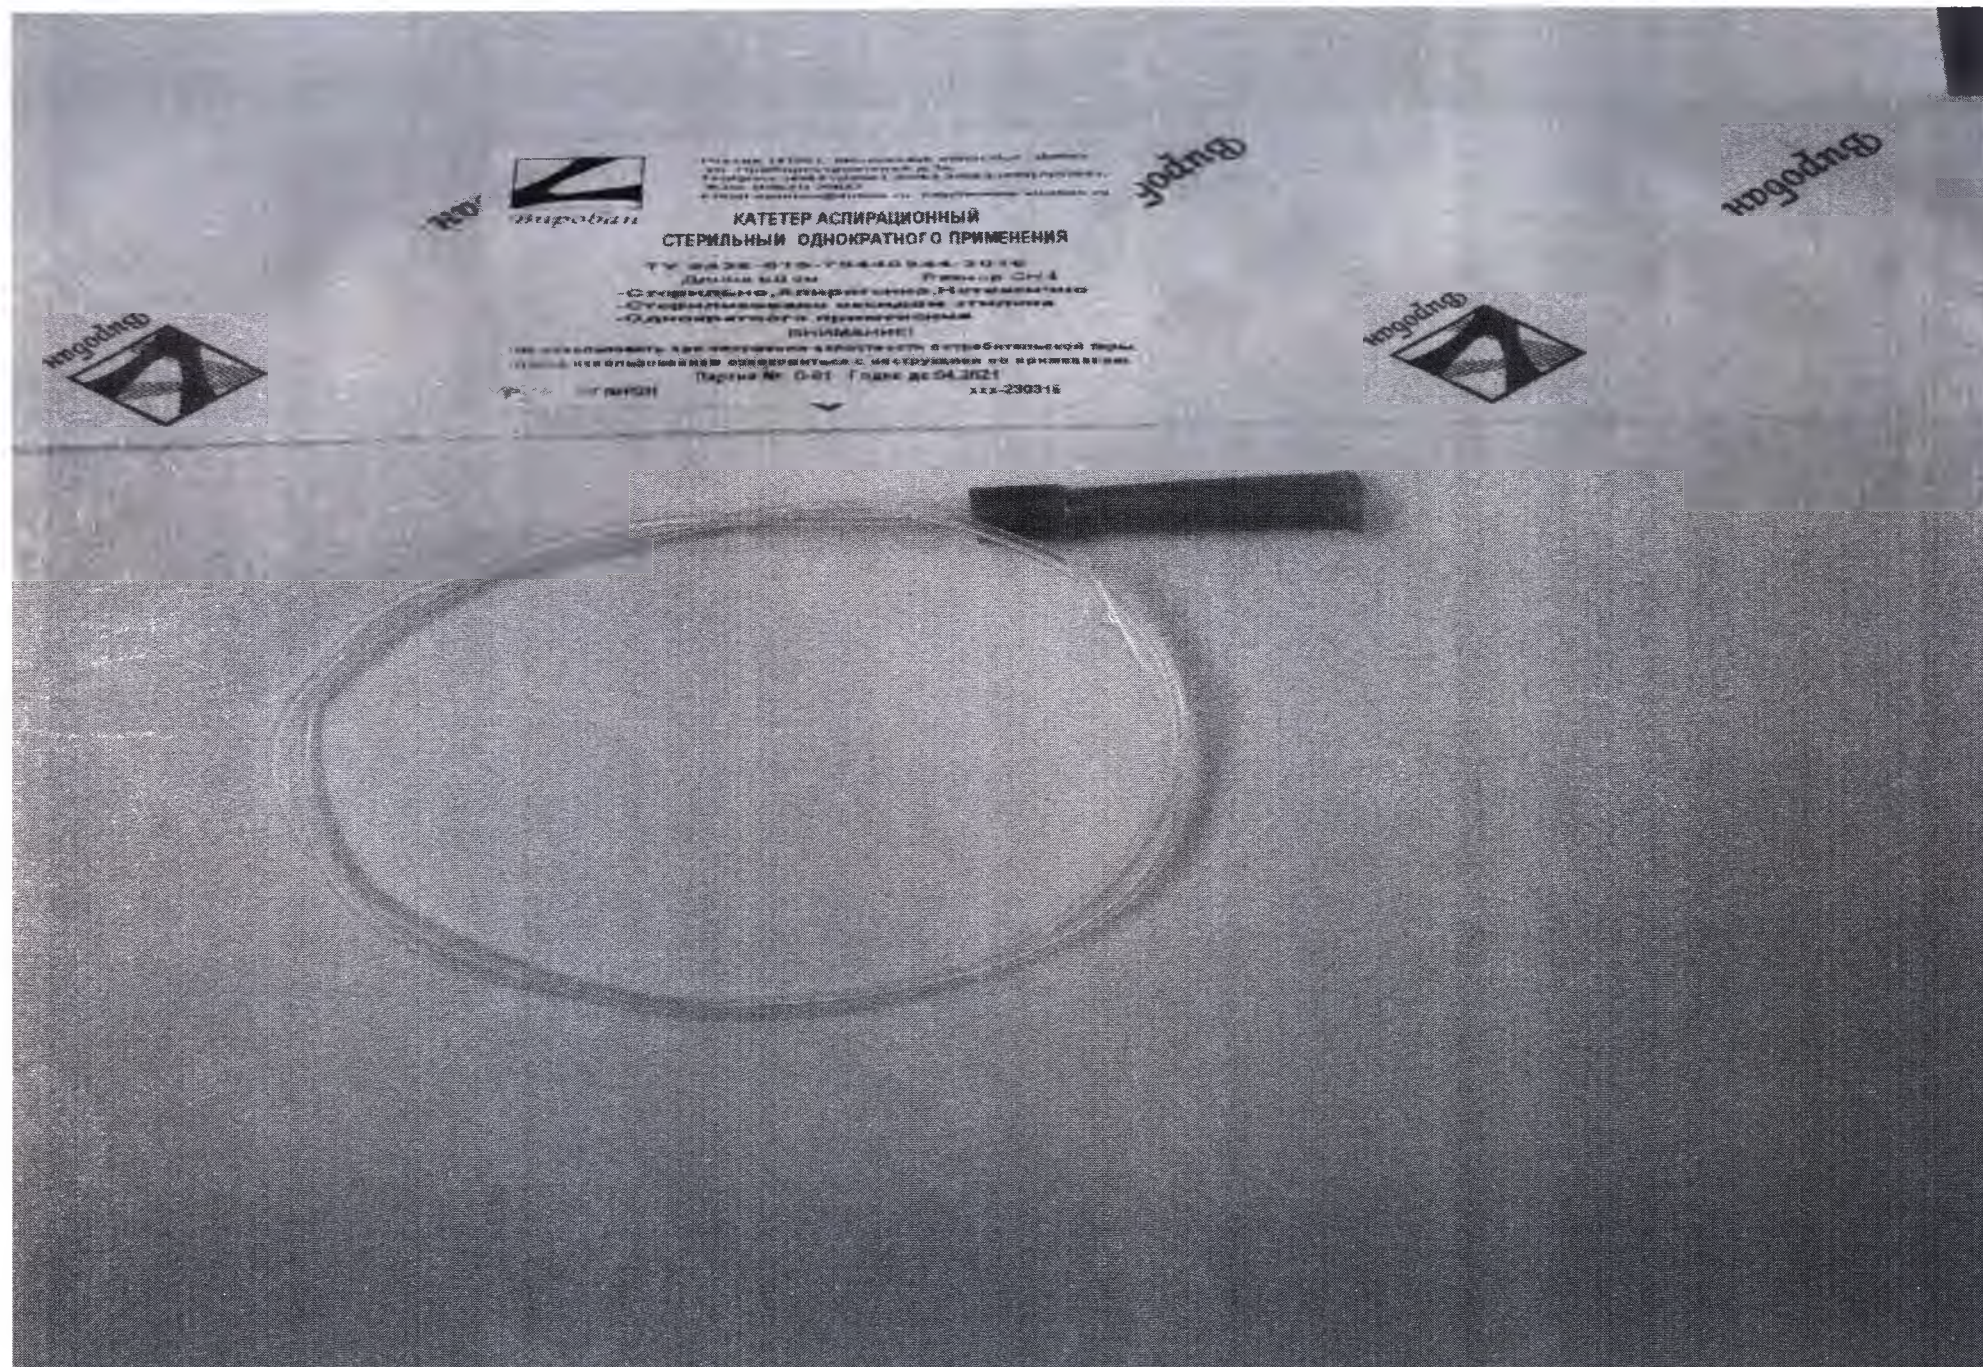

Маркировка потребительской тары Катетеры аспирационные стерильные однократного применения СН4, длина 60 см по ТУ 9436-015-70440344-2016



Виробан

Россия, 141981, Московская область, г. Дубна
ул. Приборостроителей д. 3а,
Тел/факс: (4962) 238661, 238662, 238663, (495) 7457031,
Факс: (49621) 29022
e-mail: opinion@dubna.ru, <http://www.viroban.ru>

**КАТЕТЕР АСПИРАЦИОННЫЙ
СТЕРИЛЬНЫЙ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ**

ТУ 9436-015-70440344-2016

Длина 60 см Размер СН4

- Стерильно, Апиrogenно, Нетоксично
- Стерилизовано оксидом этилена
- Однократного применения


ВНИМАНИЕ!

Не использовать при нарушении целостности потребительской тары.
Перед использованием ознакомиться с инструкцией по применению.

Партия №: 0-01 Годен до: 04.2021

РУ №РЗН

xxx-230316

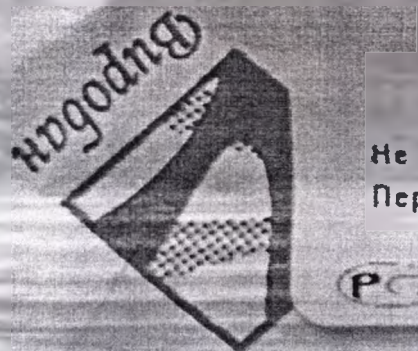




Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью ООО « Виробан»

21.08.2017 л.

Генеральный директор ООО « Виробан»

В.В. Николаев

В исполнении СН5 длина 60 см

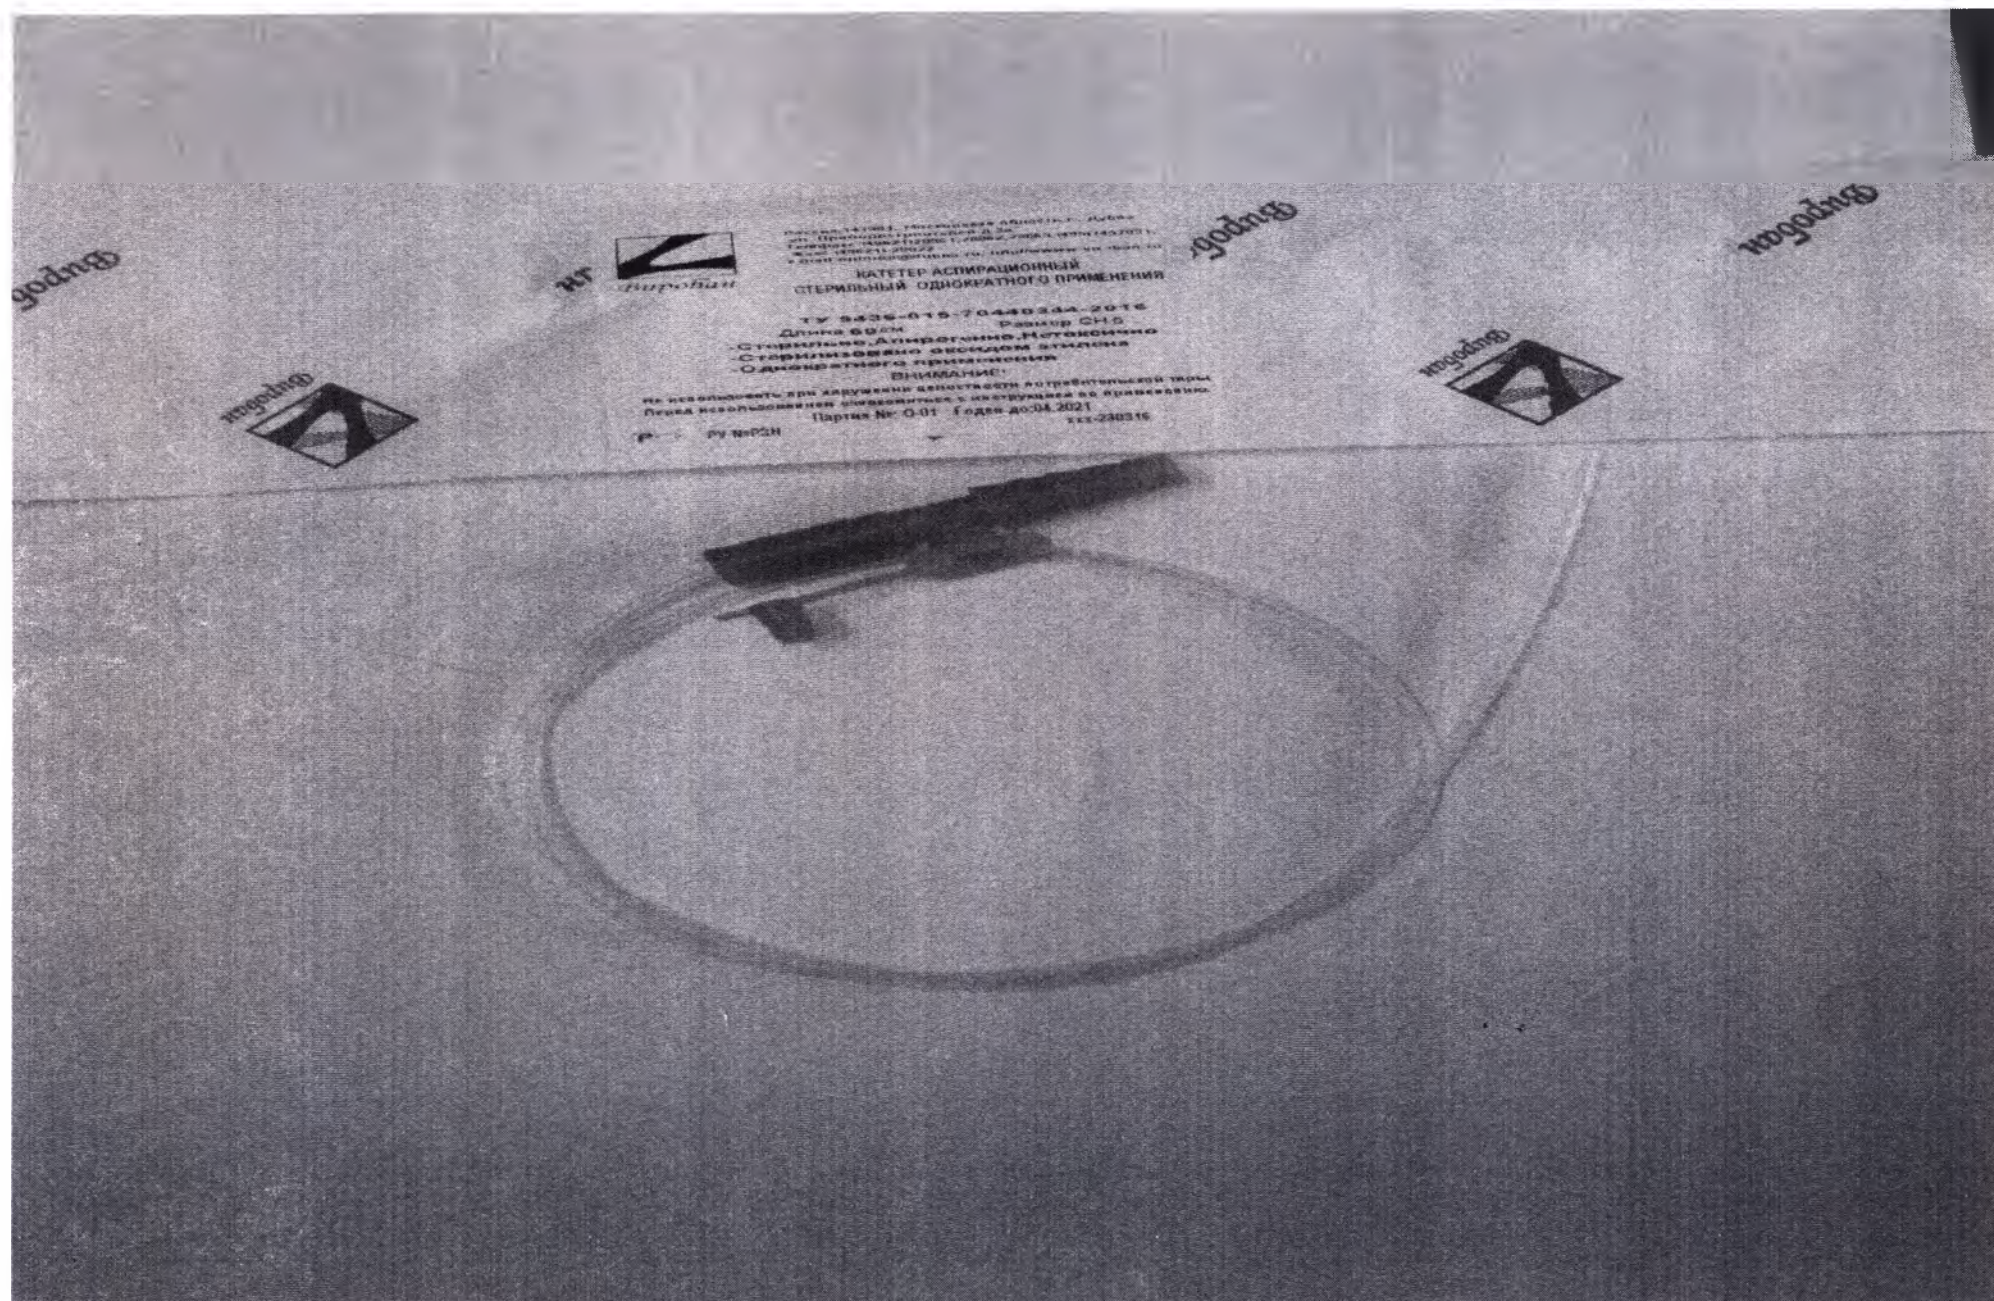



Виробан

Россия, 141981, Московская область, г. Дубна
ул. Приборостроителей д. 3а,
Тел/факс (49621) 23861, 23862, 23863, (495) 7457031;
Факс (49621) 29022
e-mail: opinion@dubna.ru, <http://www.viroban.ru>

КАТЕТЕР АСПИРАЦИОННЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

ТУ 9436-015-70440344-2016

Длина 60 см

Размер СН5

- Стерильно, Апирогенно, Нетоксично
- Стерилизовано оксидом этилена
- Однократного применения

ВНИМАНИЕ!

Не использовать при нарушении целостности потребительской тары.
Перед использованием ознакомиться с инструкцией по применению.

Партия №: 0-01 Годен до: 04.2021



РУ №РЗН

xxx-230316




Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью ООО « Виробан»

21.08.2017 л.


Генеральный директор ООО « Виробан»

В.В. Николаев

В исполнении СН6 длина 60 см

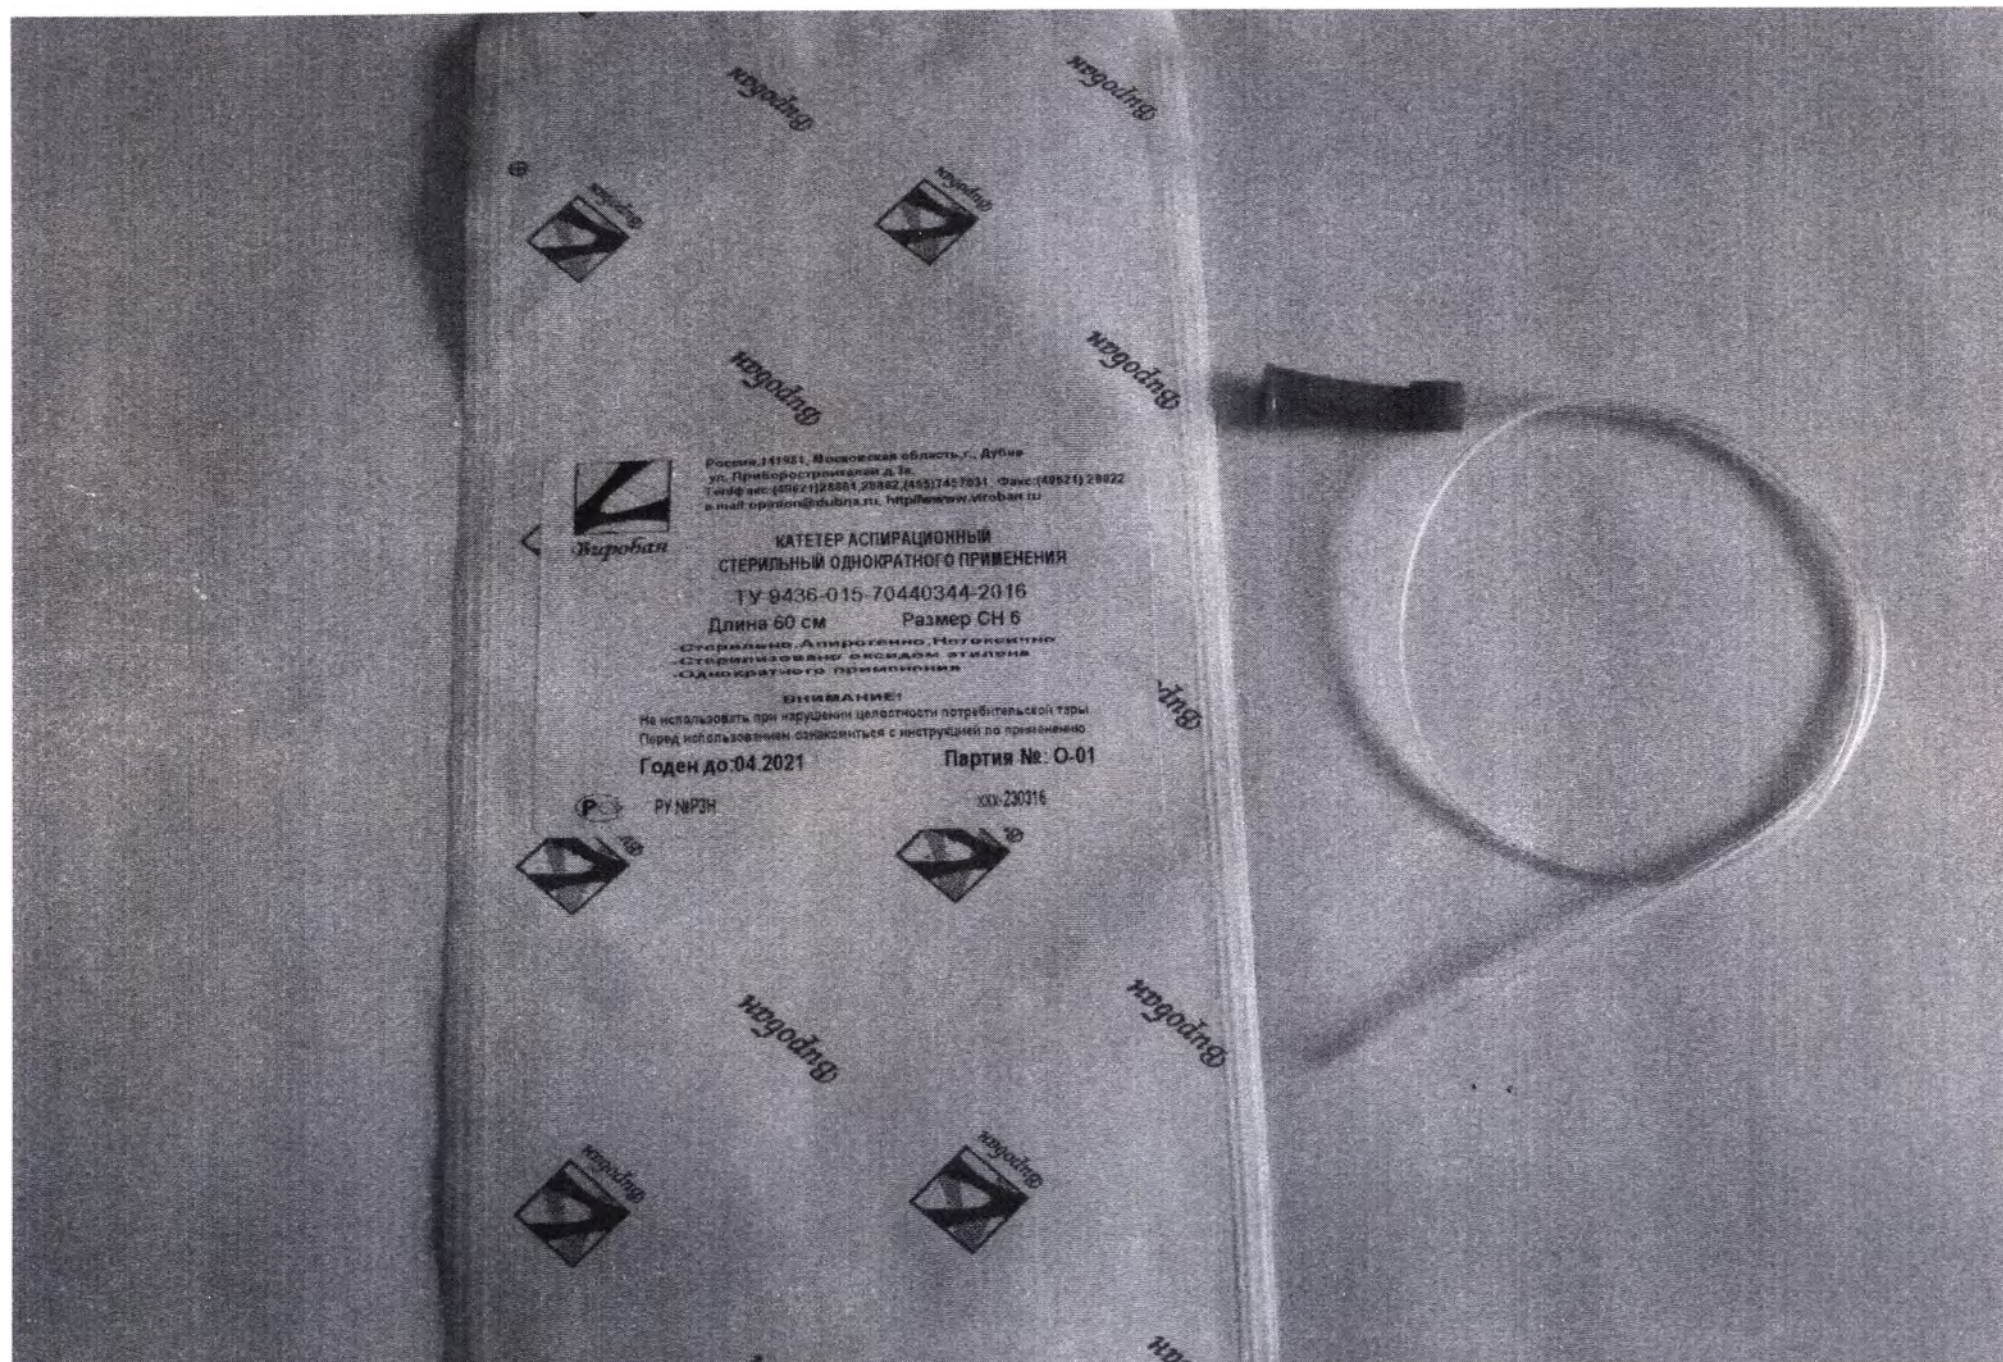

Маркировка потребительской тары Катетеры аспирационные стерильные однократного применения СН6, длина 60 см по ТУ 9436-015-70440344-2016

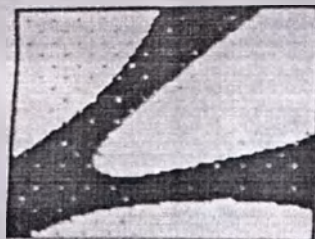

Виробан

Россия, 141981, Московская область, г. Дубна
ул. Приборостроителей д. 3а,
Тел/факс: (49621) 23861, 23862, 23863, (495) 7457031;
Факс: (49621) 29022
e-mail: opinion@dubna.ru, <http://www.viroban.ru>

**КАТЕТЕР АСПИРАЦИОННЫЙ
СТЕРИЛЬНЫЙ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ**

ТУ 9436-015-70440344-2016

Длина 60 см

Размер СН 6

- Стерильно, Апирогенно, Нетоксично**
- Стерилизовано оксидом этилена**
- Однократного применения**

ВНИМАНИЕ!

Не использовать при нарушении целостности потребительской тары.
Перед использованием ознакомиться с инструкцией по применению.

Партия №: О-01 Годен до: 04.2021



РУ №РЗН

xxx-230316




Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью ООО « Виробан»

21.08.2017 л.

Генеральный директор ООО « Виробан»

В.В. Николаев

В исполнении СН8 длина 60 см

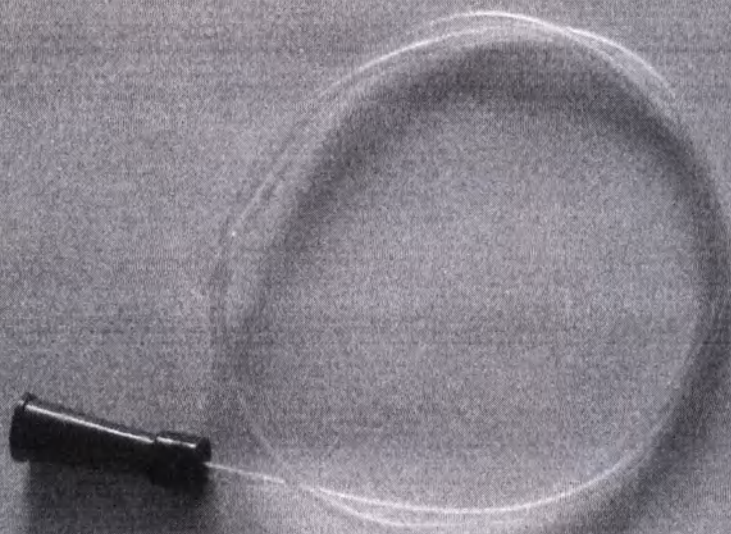

Рязань 448001, Московская область, г. Рязань
ул. Пролетарская, д. 23
Телефакс: (493) 128861, 208862, (493) 1457697; факс: (49321) 21822
e-mail: orion@orionrzn.ru, orion@orionrzn.ru

**КАТЕТЕР АСПИРАЦИОННЫЙ
СТЕРИЛЬНЫЙ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ**

ТУ 9436-015-70440344-2016

Длина 60 см Размер СН 8
Стерильно. Асептично. Натянуто.
Стерилизовано методом этилирования.
Однократного применения.

ВНИМАНИЕ!

Не использовать при нарушении целостности полимерной тары.
Перед использованием ознакомиться с инструкцией по применению.

Годен до: 04.2021

Партия №: О-01

РУ №231

xxx-200316

Маркировка потребительской тары Катетеры аспирационные стерильные однократного применения СН8 ,длина 60 см по ТУ 9436-015-70440344-2016



Виробан

Россия, 141981 Московская область, г. Дубна
ул. Приборостроителей д.3а,
Тел/факс (49621) 28861, 28862, 28863, (495) 7457031;
Факс (49621) 29022
e-mail: opinion@dubna.ru, <http://www.viroban.ru>

**КАТЕТЕР АСПИРАЦИОННЫЙ
СТЕРИЛЬНЫЙ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ**

ТУ 9436-015-70440344-2016

Длина 60 см Размер СН 8

- Стерильно, Апирогенно, Нетоксично
- Стерилизовано оксидом этилена
- Однократного применения

ВНИМАНИЕ!

Не использовать при нарушении целостности потребительской тары
Перед использованием ознакомиться с инструкцией по применению.

Партия №: 0-01 Годен до: 04.2021



РУ №РЗН

xxx-230316

на год




Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью ООО « Виробан»

21.08.2017 л.

Генеральный директор ООО « Виробан»

В.В. Николаев

В исполнении СН10 длина 60 см

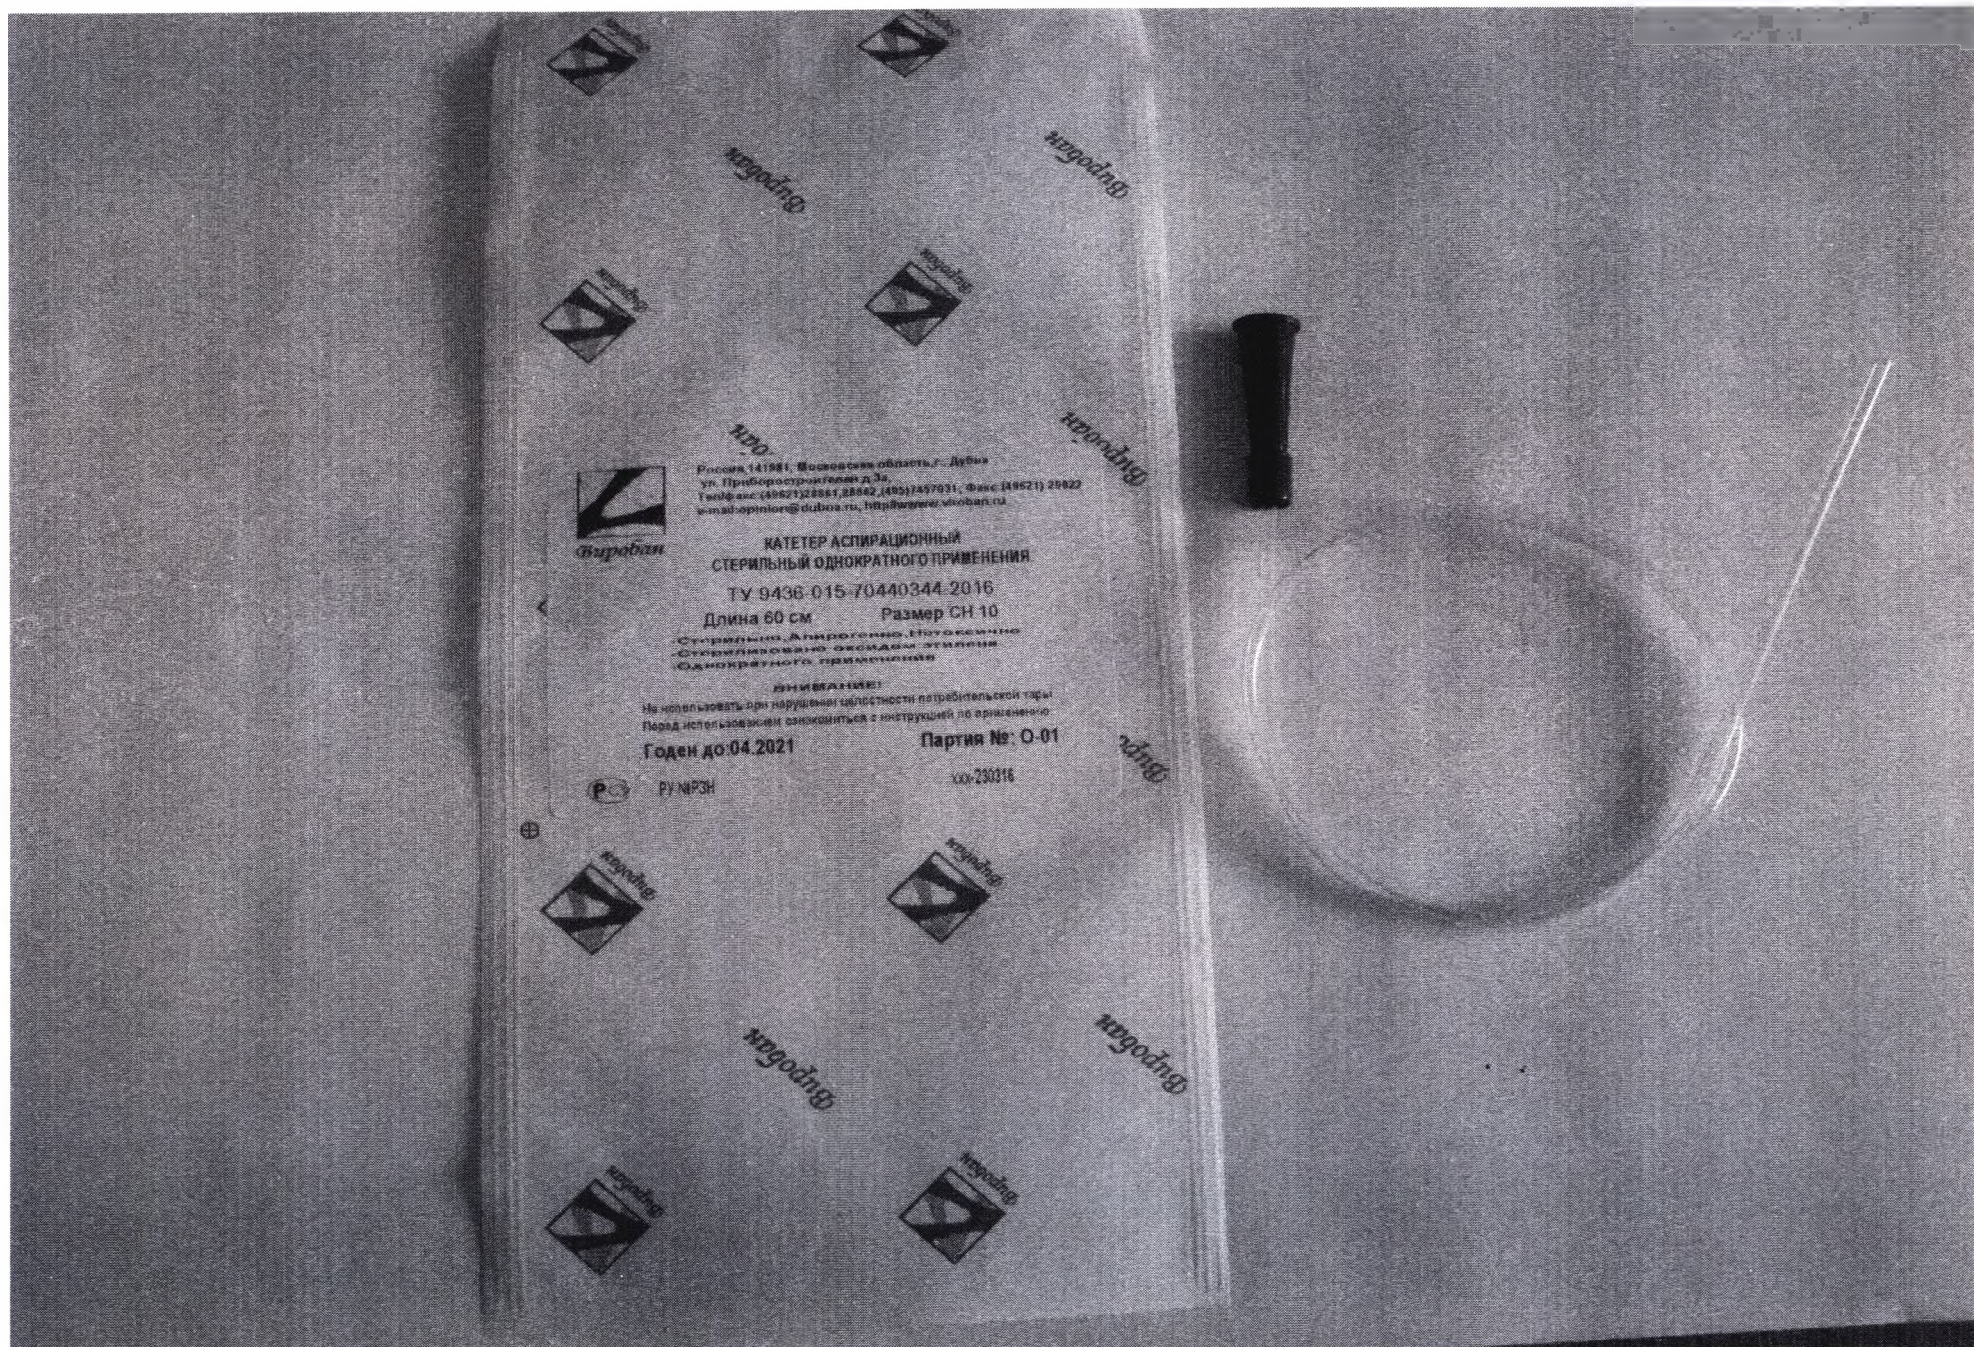

Маркировка потребительской тары Катетеры аспирационные стерильные однократного применения СН10 ,длина 60 см по ТУ 9436-015-70440344-2016



Виробан

Россия, 141981, Московская область г., Дубна
ул. Приборостроителей д.3а,
Тел/факс: (496 21) 2386 1, 2386 2, 2386 3. (495) 745 7031;
Факс (496 21) 29022
e-mail: opinion@dubna.ru, <http://www.viroban.ru>

**КАТЕТЕР АСПИРАЦИОННЫЙ
СТЕРИЛЬНЫЙ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ**

ТУ 9436-015-70440344-2016

Длина 60 см


Размер СН 10

- Стерильно, Апирогенно, Нетоксично**
- Стерилизовано оксидом этилена**
- Однократного применения**

ВНИМАНИЕ!

**Не использовать при нарушении целостности потребительской тары
Перед использованием ознакомиться с инструкцией по применению.**

Партия №: О-01 Годен до: 04.2021



РУ №РЗН

xxx-230316




Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью ООО « Виробан»

21.08.2017 л.


Генеральный директор ООО « Виробан»

В.В. Николаев

В исполнении СН12 длина 60 см

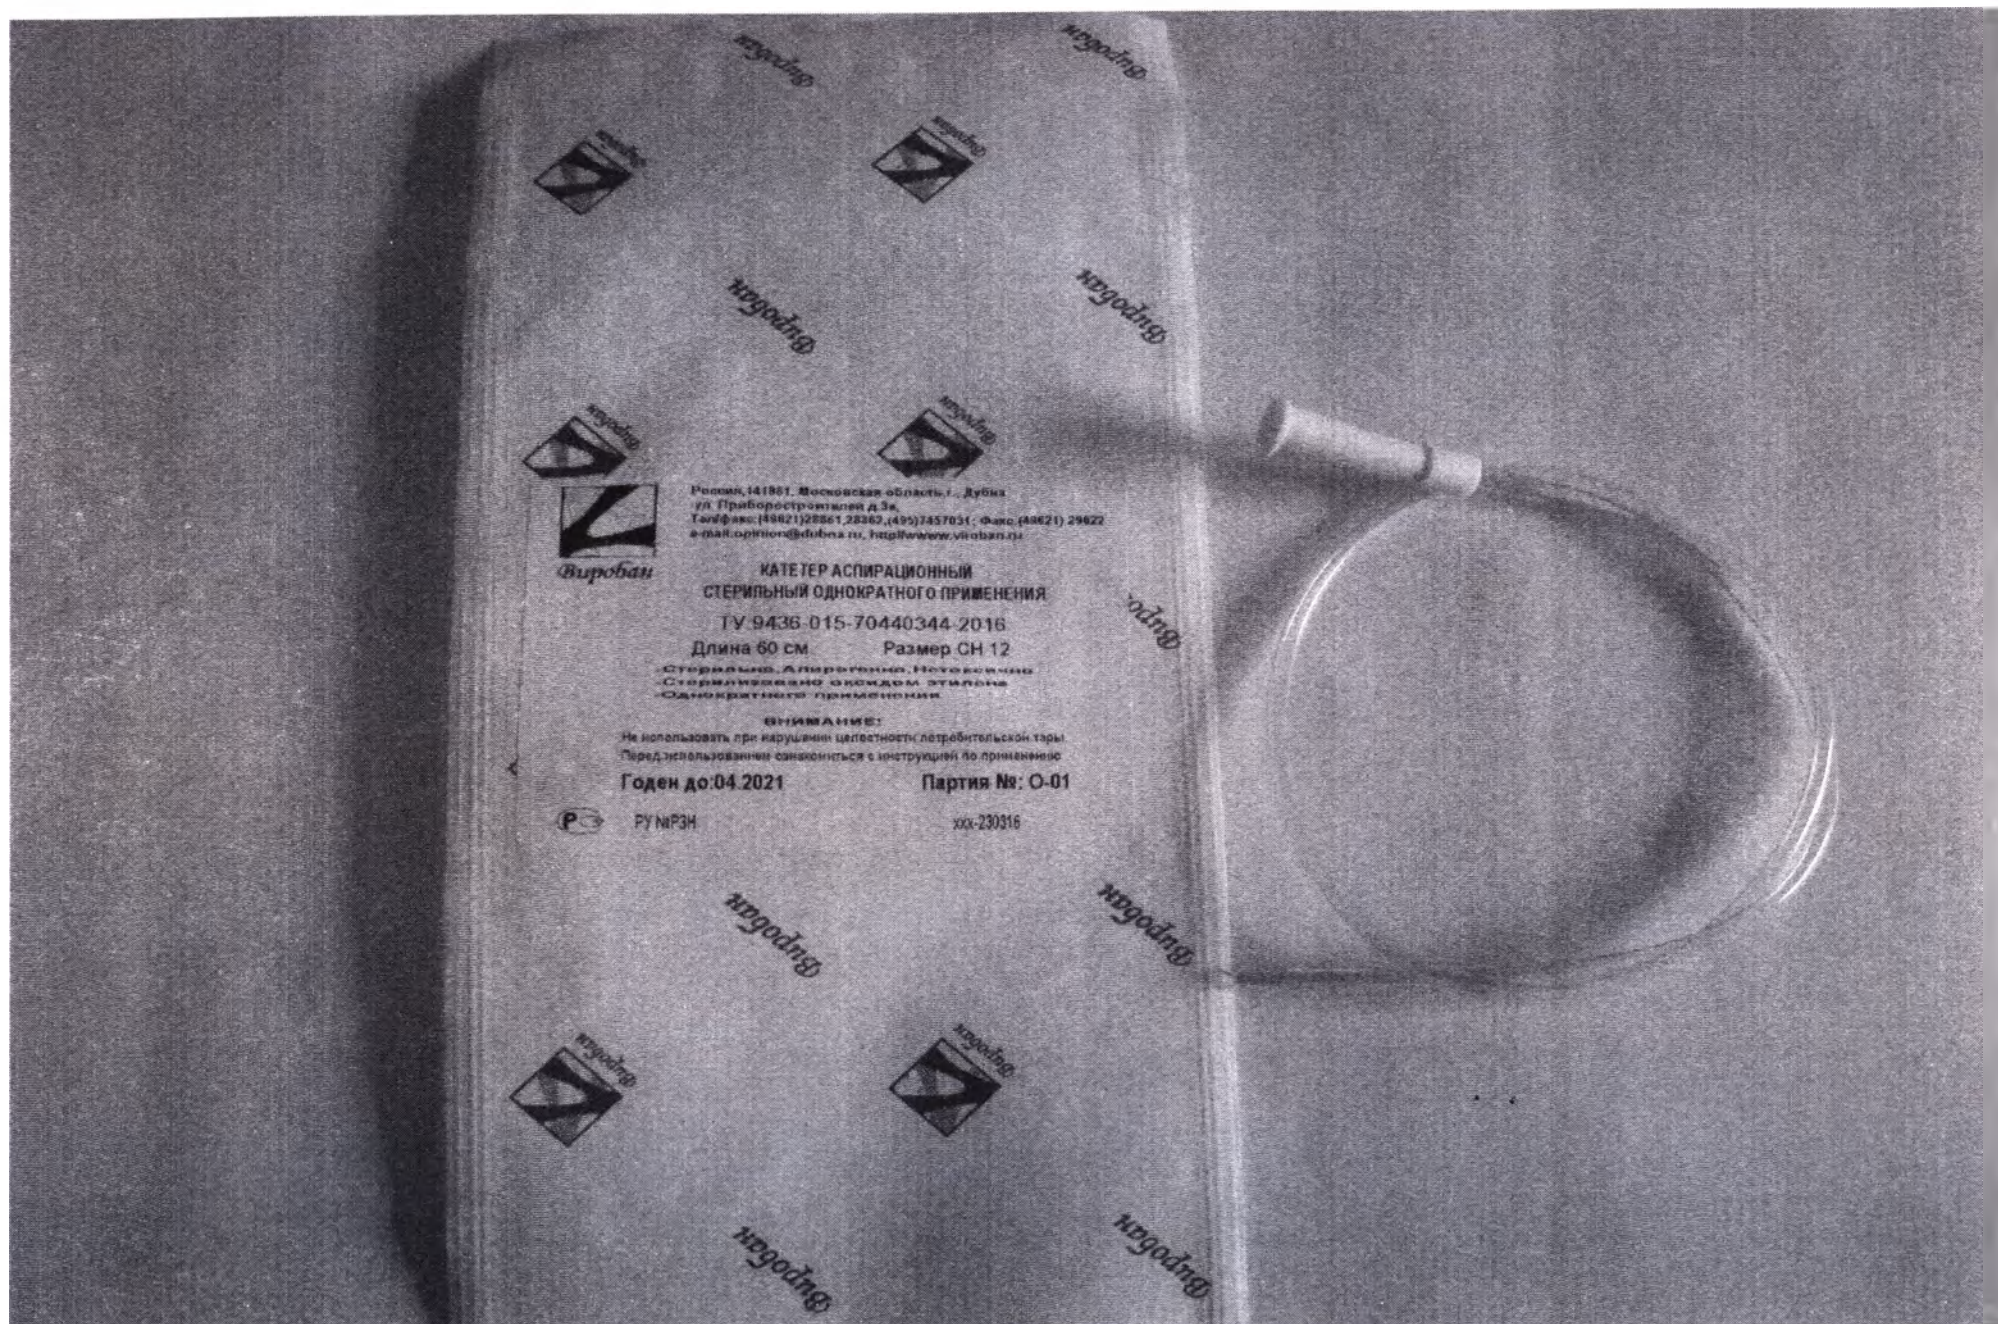

Маркировка потребительской тары Катетеры аспирационные стерильные однократного применения СН12 ,длина 60 см по ТУ 9436-015-70440344-2016



Виробан

Россия, 141981, Московская область г. Дубна
ул. Приборостроителей д.3а,
Тел/факс (49621) 28861, 28862, 28863, (495) 7457031
Факс (49621) 29022
e-mail: opinionon@dubna.ru, <http://www.viroban.ru>

**КАТЕТЕР АСПИРАЦИОННЫЙ
СТЕРИЛЬНЫЙ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ**

ТУ 9436-015-70440344-2016

Длина 60 см


Размер СН 12

- Стерильно, Апирогенно, Нетоксично
- Стерилизовано оксидом этилена
- Однократного применения

ВНИМАНИЕ!

Не использовать при нарушении целостности потребительской тары.
Перед использованием ознакомиться с инструкцией по применению.

Партия №: О-01 Годен до: 04.2021



РУ №РЗН

xxx-230316






Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью ООО « Виробан»

21.08.2017 л.


Генеральный директор ООО « Виробан»

В.В. Николаев

В исполнении СН14 длина 60 см

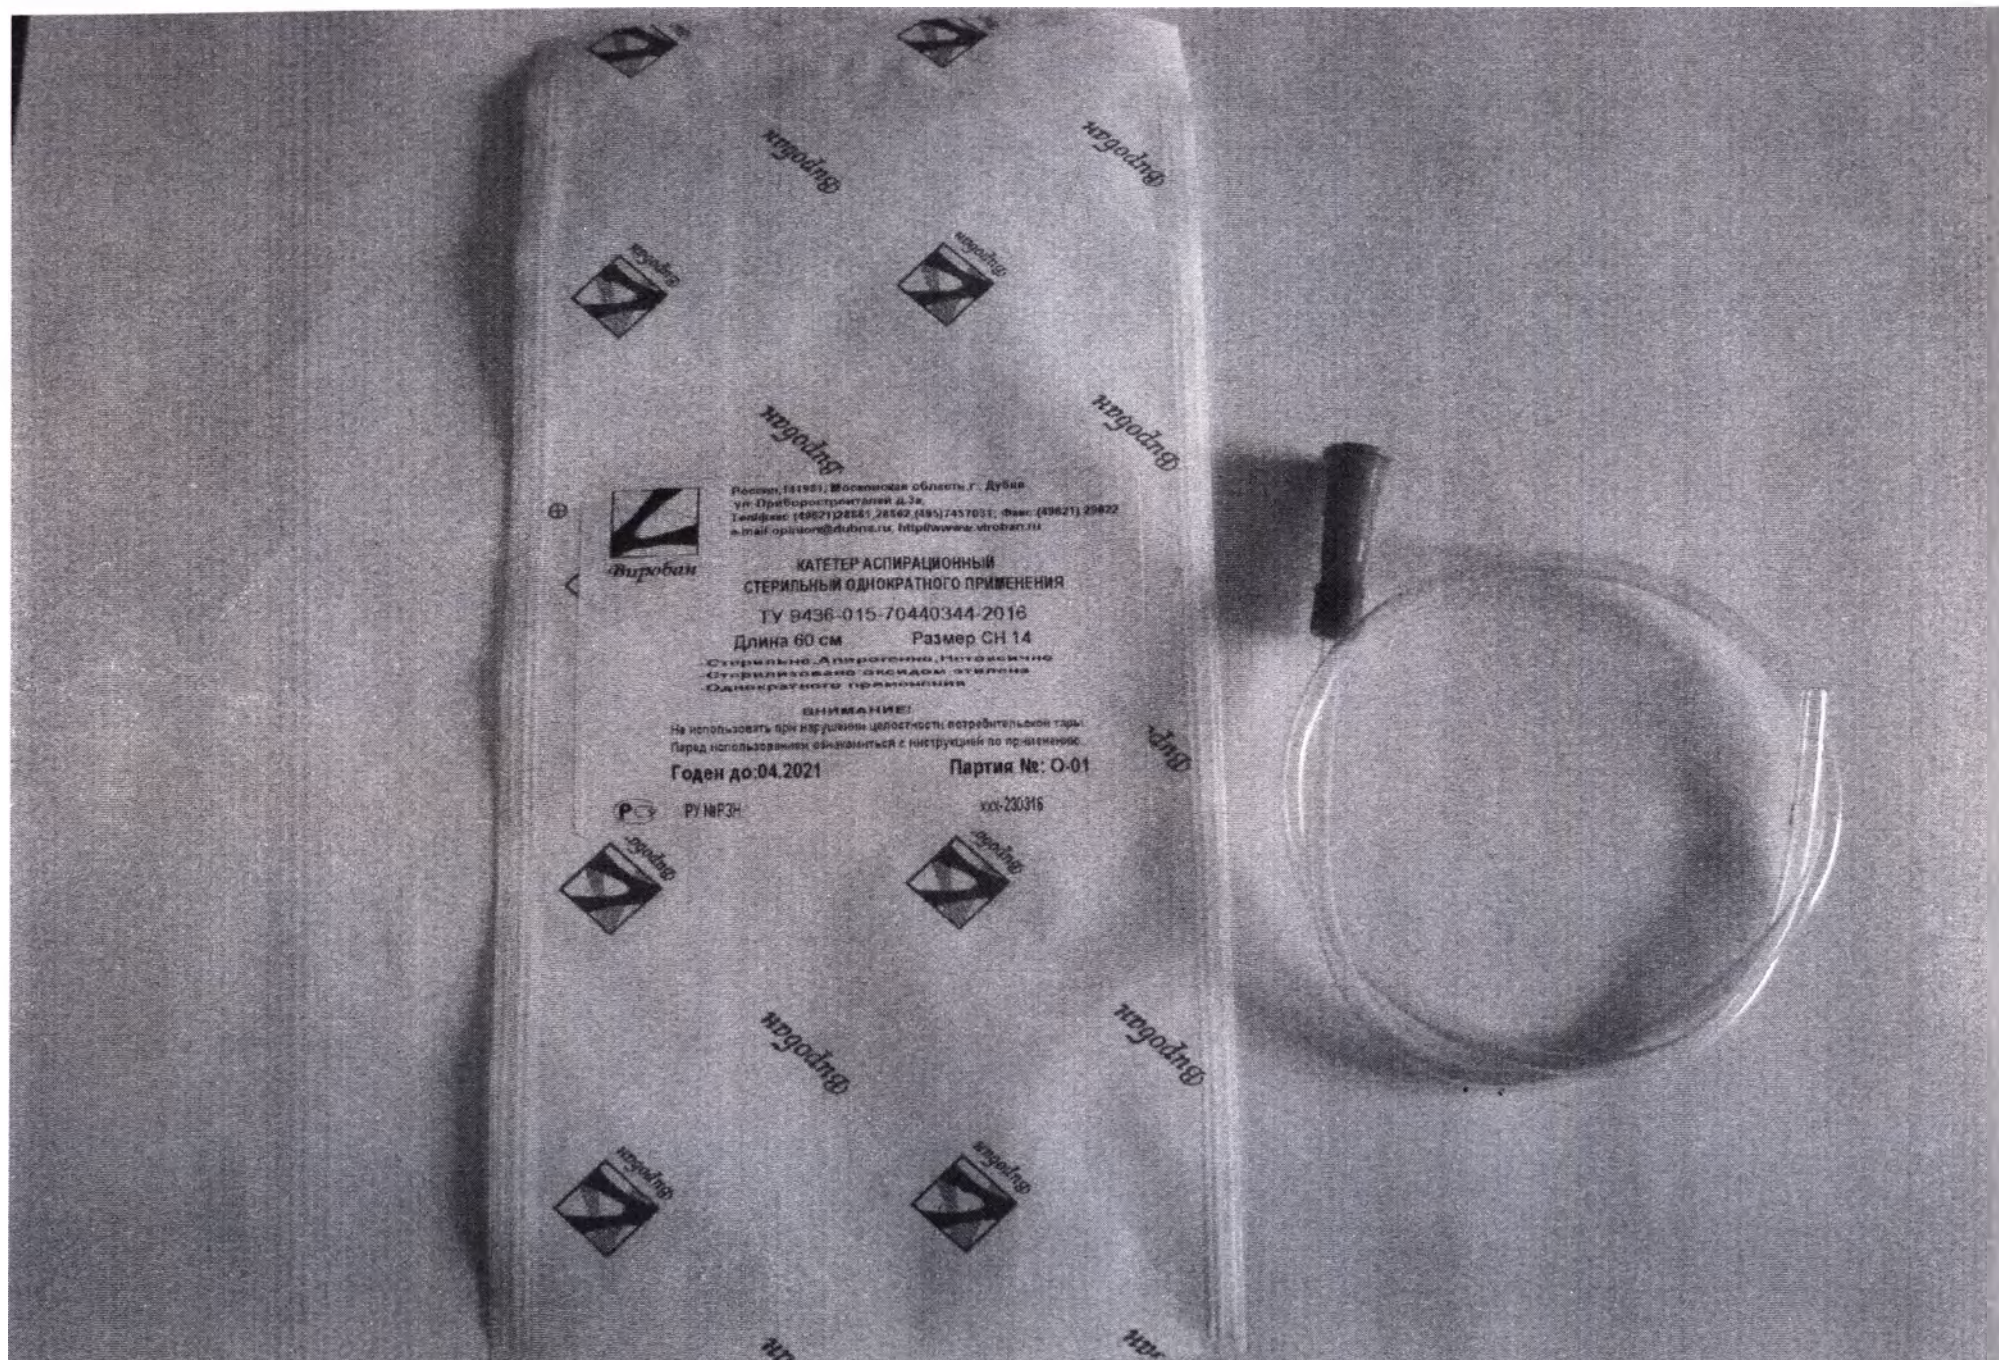

Маркировка потребительской тары Катетеры аспирационные стерильные однократного применения СН14 ,длина 60 см по ТУ 9436-015-70440344-2016



Виробан

Россия, 141981, Московская область, г. Дубна
ул. Приборостроителей д.3а,
Тел/факс. (49621) 28861, 28362, 28863, (495) 7451031,
Факс. (49621) 29022
e-mail: opinion@dubna.ru, <http://www.viroban.ru>

**КАТЕТЕР АСПИРАЦИОННЫЙ
СТЕРИЛЬНЫЙ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ**

ТУ 9436-015-70440344-2016

Длина 60 см


Размер СН 14

- Стерильно, Апирогенно, Нетоксично**
- Стерилизовано оксидом этилена**
- Однократного применения**

ВНИМАНИЕ!


Не использовать при нарушении целостности потребительской тары.
Перед использованием ознакомиться с инструкцией по применению.

Партия №: 0-01 Годен до: 04.2021



РУ №РЗН

xxx-230316

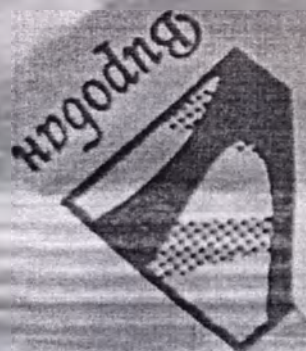




Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью ООО « Виробан»

21.08.2017 л.

Генеральный директор ООО « Виробан»

В.В. Николаев

В исполнении СН16 длина 60 см

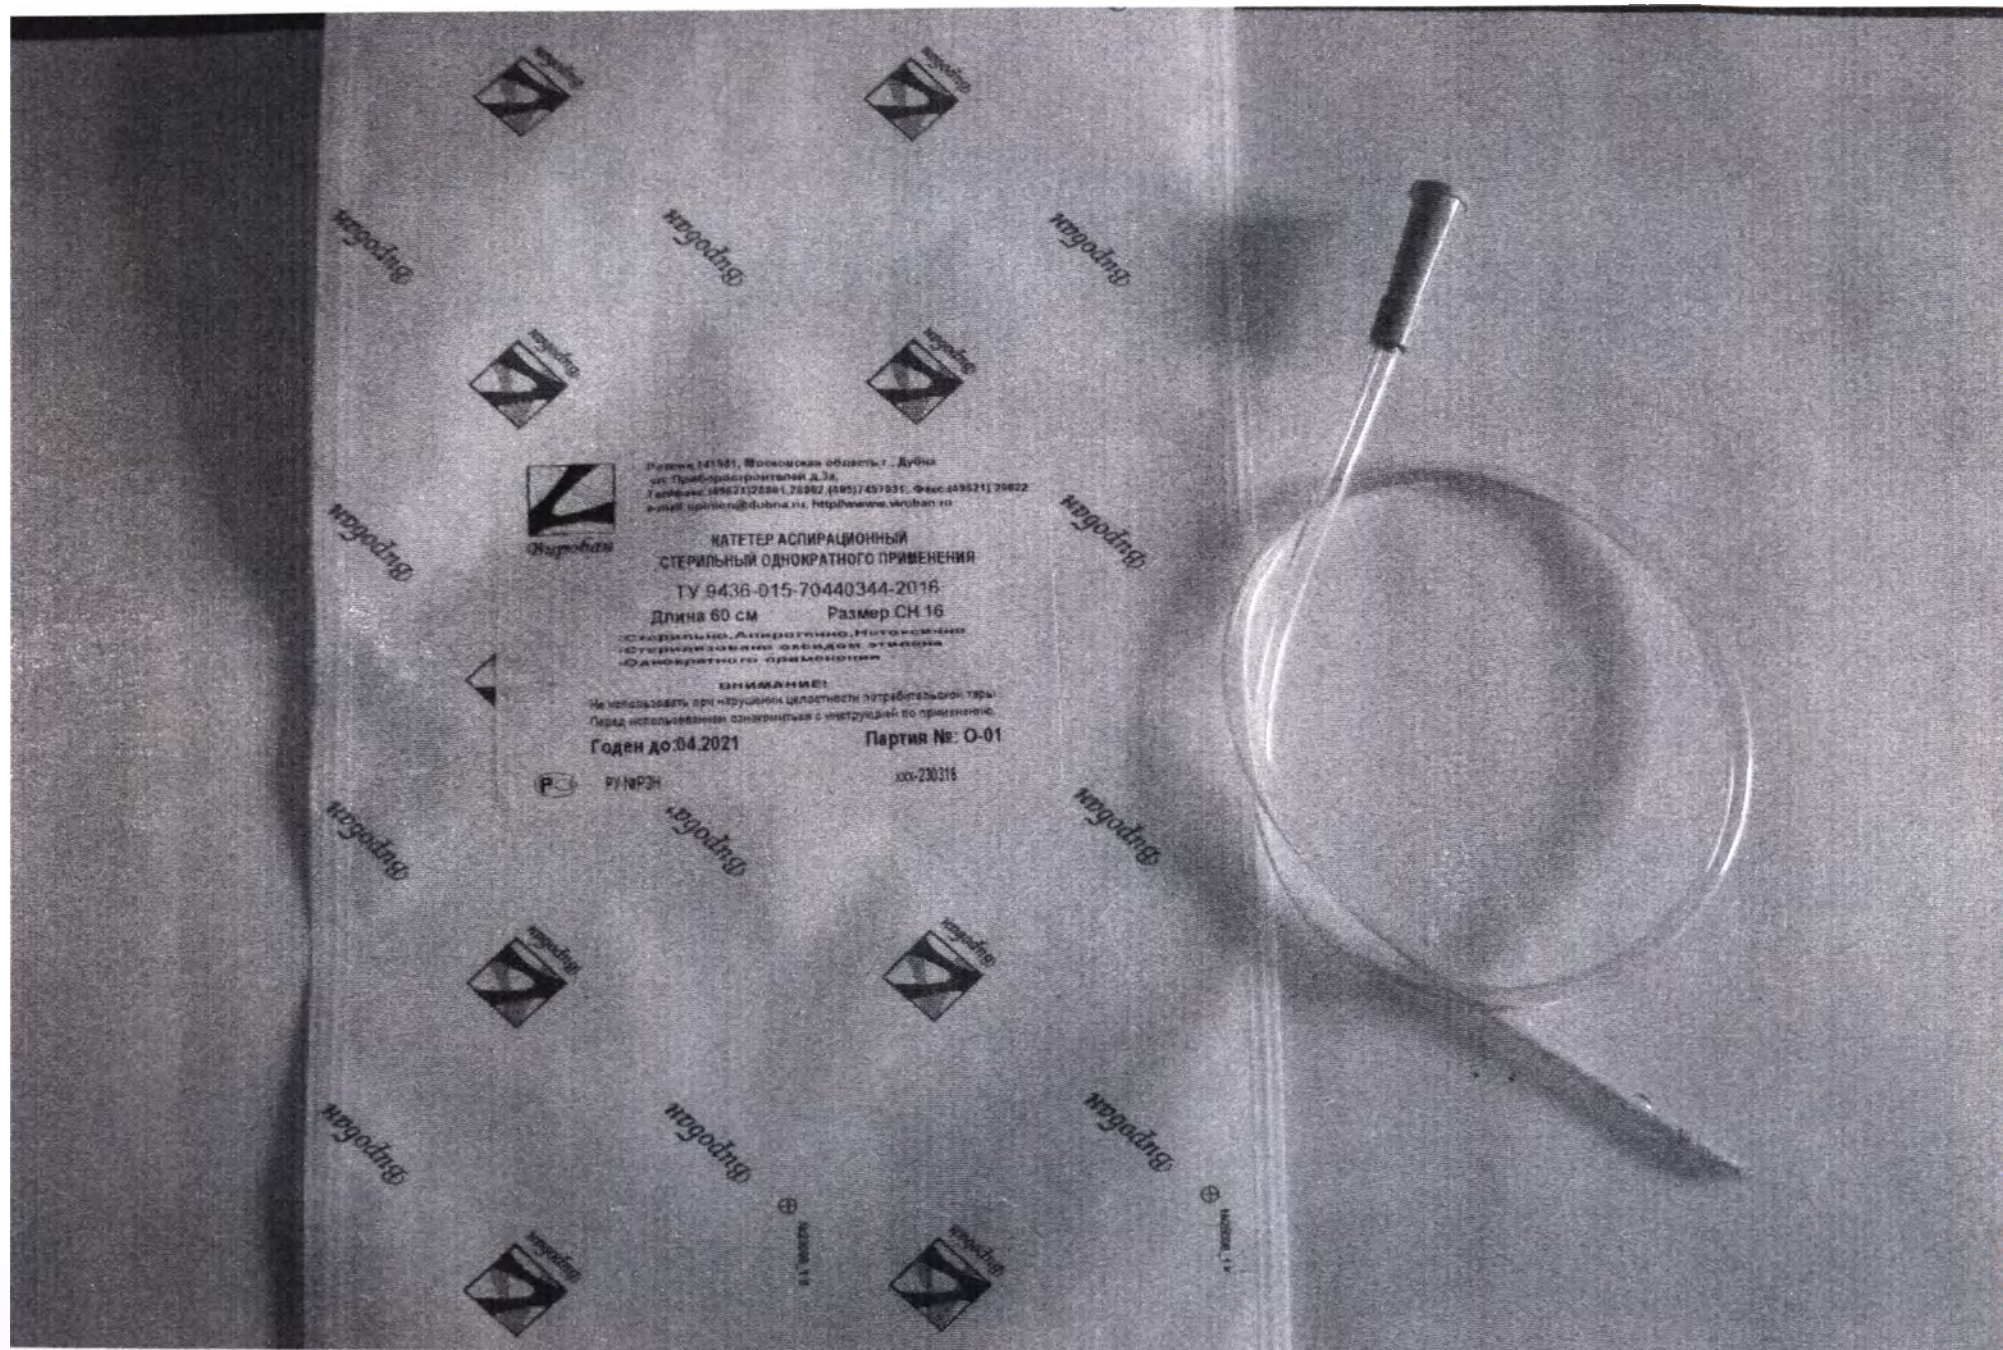

Маркировка потребительской тары Катетеры аспирационные стерильные однократного применения СН16 ,длина 60 см по ТУ 9436-015-70440344-2016



Виробан

Россия, 141981, Московская область, г. Дубна
ул. Приборостроителей д.3а,
Тел/факс: (49621) 23861, 28862, 28863, (495) 745 7031,
Факс (49621) 29022
e-mail: opinion@dubna.ru, <http://www.viroban.ru>

**КАТЕТЕР АСПИРАЦИОННЫЙ
СТЕРИЛЬНЫЙ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ**

ТУ 9436-015-70440344-2016

Длина 60 см

Размер СН16

- Стерильно, Апиногенно, Нетоксично**
- Стерилизовано оксидом этилена**
- Однократного применения**

ВНИМАНИЕ!

**Не использовать при нарушении целостности потребительской тары
Перед использованием ознакомиться с инструкцией по применению.**

Партия №: О-01 Годен до: 04.2021

РОС RU №РЗН

xxx-230316



Виробан



Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью ООО « Виробан»

21.08.2017 л.

Генеральный директор ООО « Виробан»

В.В. Николаев



Виробан

Россия, 141981, Московская область, г. Дубна
ул. Приборостроителей д.3а,
Тел/факс (49621) 23861, 26862, 28663, (495) 7457031,
Факс (49621) 29022
e-mail opinion@dubna.ru, <http://www.viroban.ru>

**КАТЕТЕР АСПИРАЦИОННЫЙ
СТЕРИЛЬНЫЙ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ**

ТУ 9436-015-70440344-2016

Длина 60 см


Размер СН 18

- Стерильно, Апирогенно, Нетоксично**
- Стерилизовано оксидом этилена**
- Однократного применения**

ВНИМАНИЕ!

**Не использовать при нарушении целостности потребительской тары.
Перед использованием ознакомиться с инструкцией по применению.**

Партия №: 0-01 Годен до: 04.2021



РУ №РЗН

xxx-230316





Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью ООО « Виробан»

21.08.2017 л.

Генеральный директор ООО « Виробан»

В.В. Николаев



В исполнении СН20 длина 60 см








Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью ООО « Виробан»


21.08.2017 л.

Генеральный директор ООО « Виробан»

В.В. Николаев

В исполнении СН22 длина 60 см

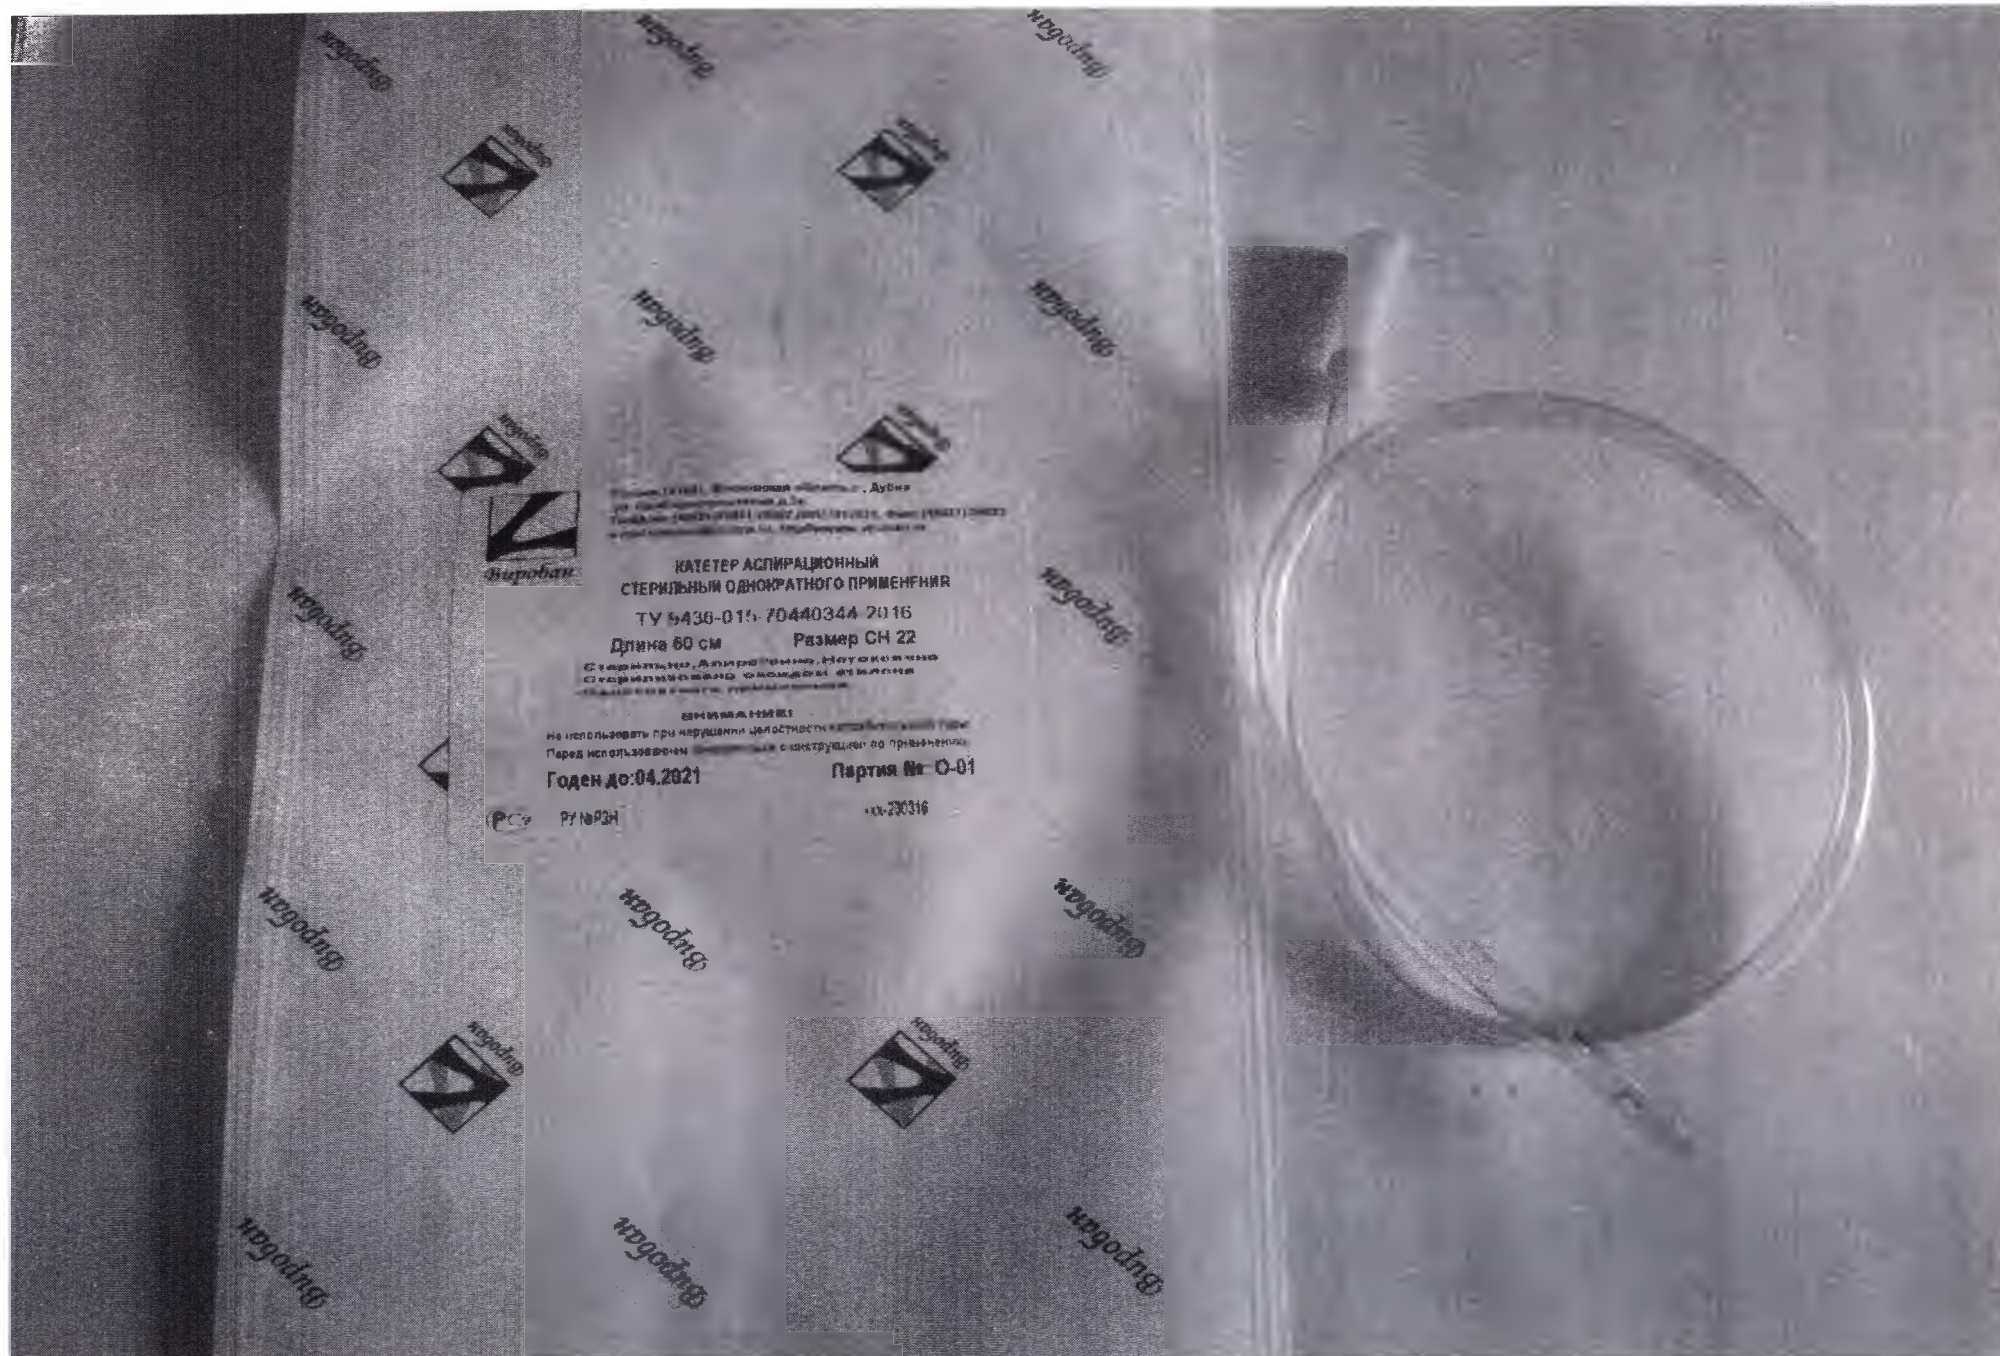



Виробан

Россия 141981 Московская область г. Дубна
ул. Приборостроителей д. 3а
Тел/факс: (4962) 20861, 20862, 20863, 4450745/003
Факс (49621) 29022
e-mail: orinop@dubna.ru, <http://www.viroban.ru>

**КАТЕТЕР АСПИРАЦИОННЫЙ
СТЕРИЛЬНЫЙ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ**

ТУ 9436-015-70440344-2016

Длина 60 см

Размер СН 22

- Стерильно, Апиrogenно, Нетоксично
- Стерилизовано оксидом этилена
- Однократного применения

ВНИМАНИЕ!

Не использовать при нарушении целостности потребительской тары
Перед использованием ознакомиться с инструкцией по применению.

Партия №: 0-01 Годен до: 04.2021

ру №РЗН

xxx-230316




Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью ООО « Виробан»

21.08.2017 л.

Генеральный директор ООО « Виробан»

В.В. Николаев

В исполнении СН24 длина 60 см

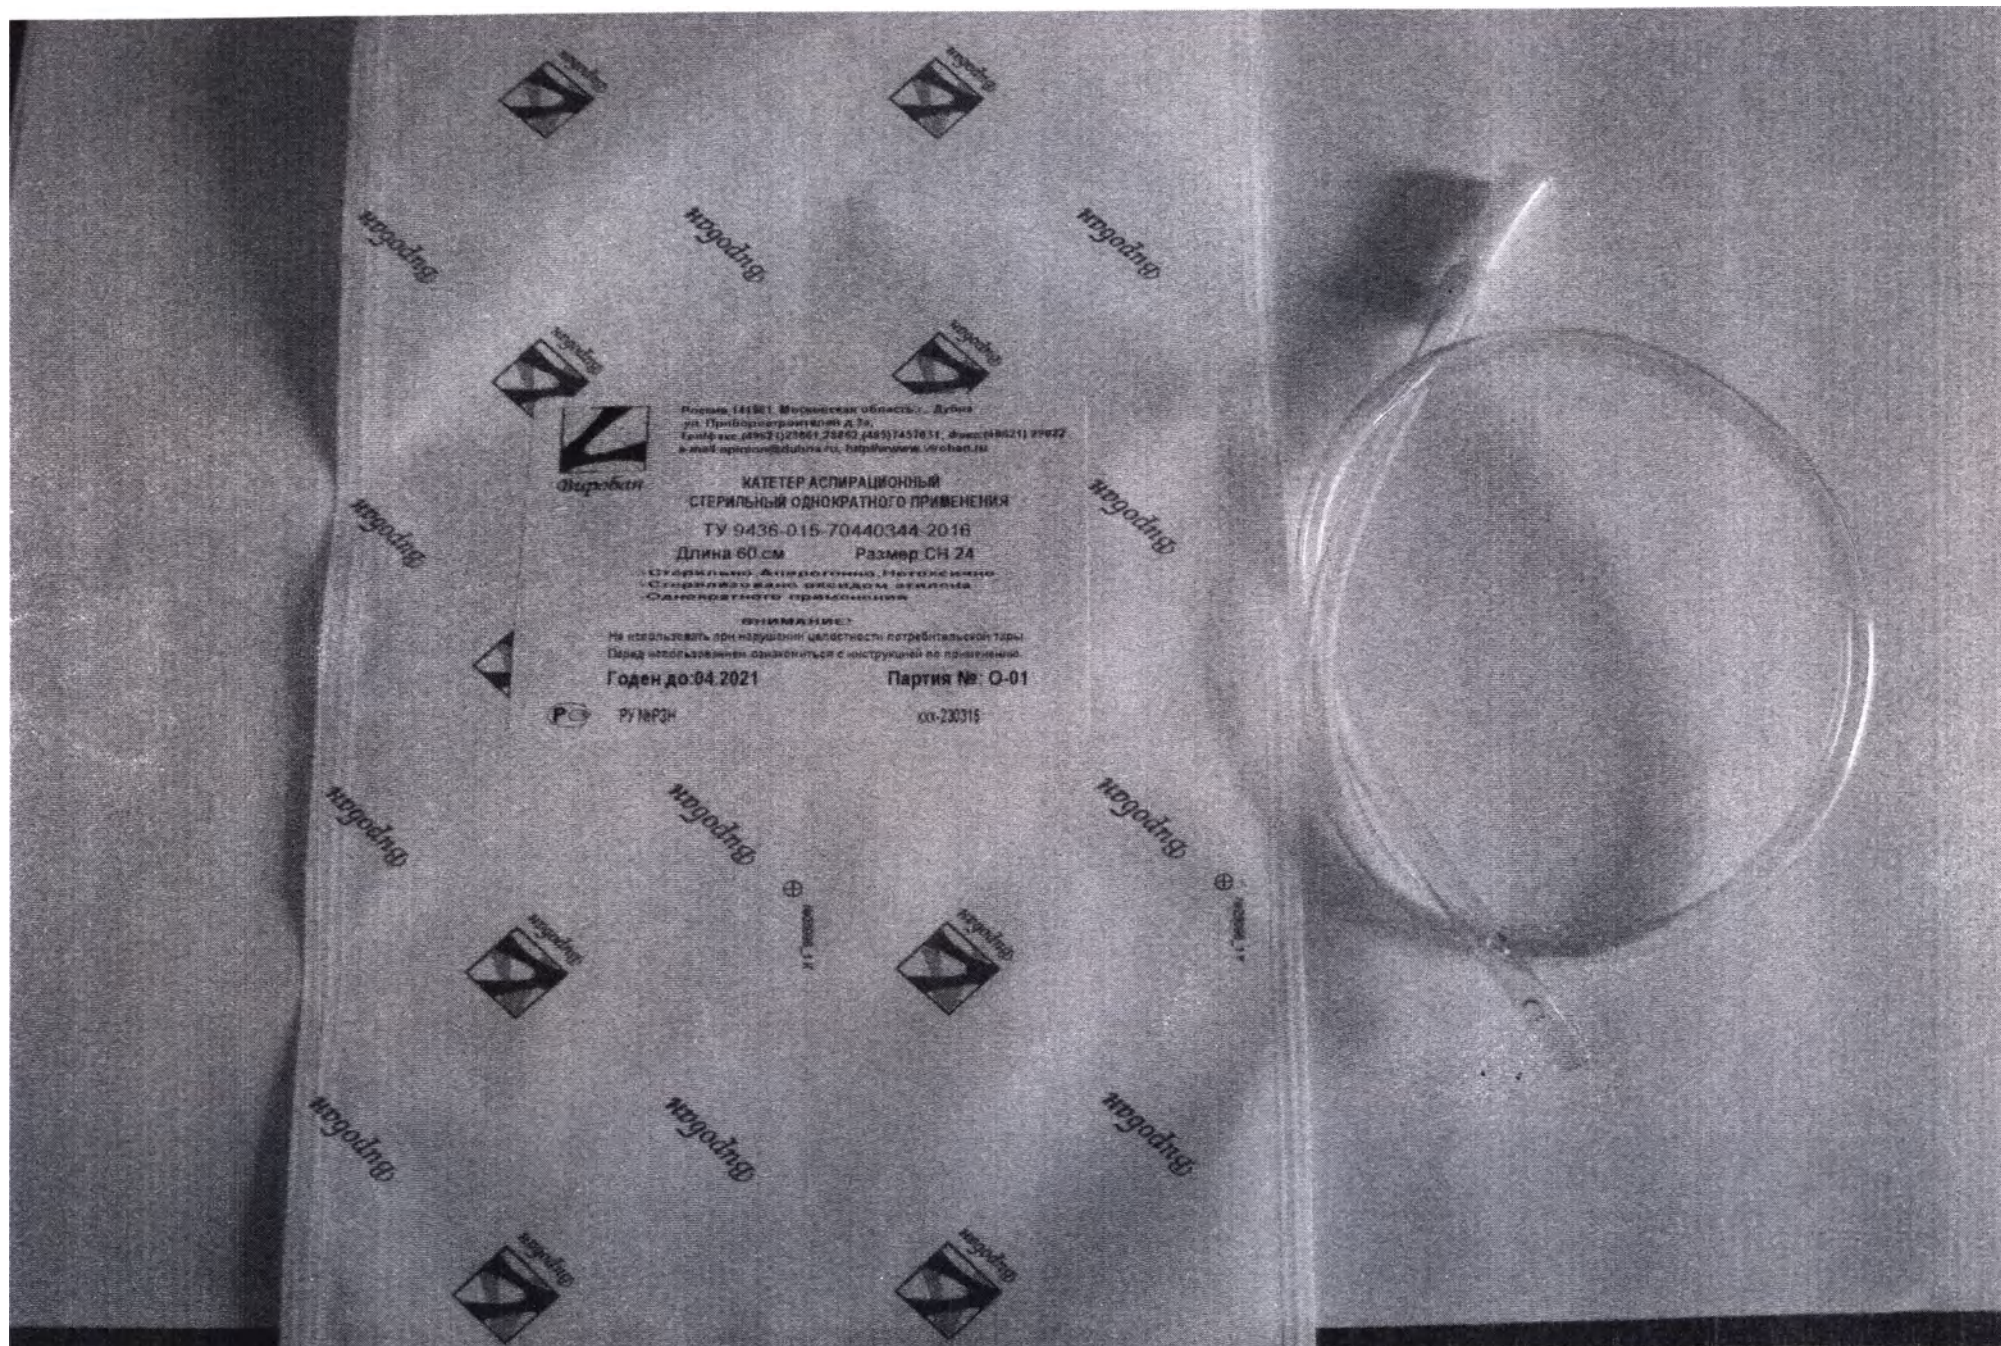



Виробан

Россия, 141981, Московская область г., Дубна
ул. Приборостроителей д.3а,
Тел/факс (49621) 28861, 28862, 28863, (495) 7457031;
Факс (49621) 29022
e-mail: opinion@dubna.ru, <http://www.viroban.ru>

**КАТЕТЕР АСПИРАЦИОННЫЙ
СТЕРИЛЬНЫЙ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ**

ТУ 9436-015-70440344-2016

Длина 60 см

Размер СН 24

- Стерильно, Апирогенно, Нетоксично**
- Стерилизовано оксидом этилена**
- Однократного применения**

ВНИМАНИЕ!

**Не использовать при нарушении целостности потребительской тары
Перед использованием ознакомиться с инструкцией по применению.**

Партия №: 0-01 Годен до: 04.2021



РУ №РЗН

xxx-230316




Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью ООО « Виробан»

21.08.2017 л.


Генеральный директор ООО « Виробан»
В.В. Николаев



В исполнении с вакуумконтролем СН4 длина 53 см

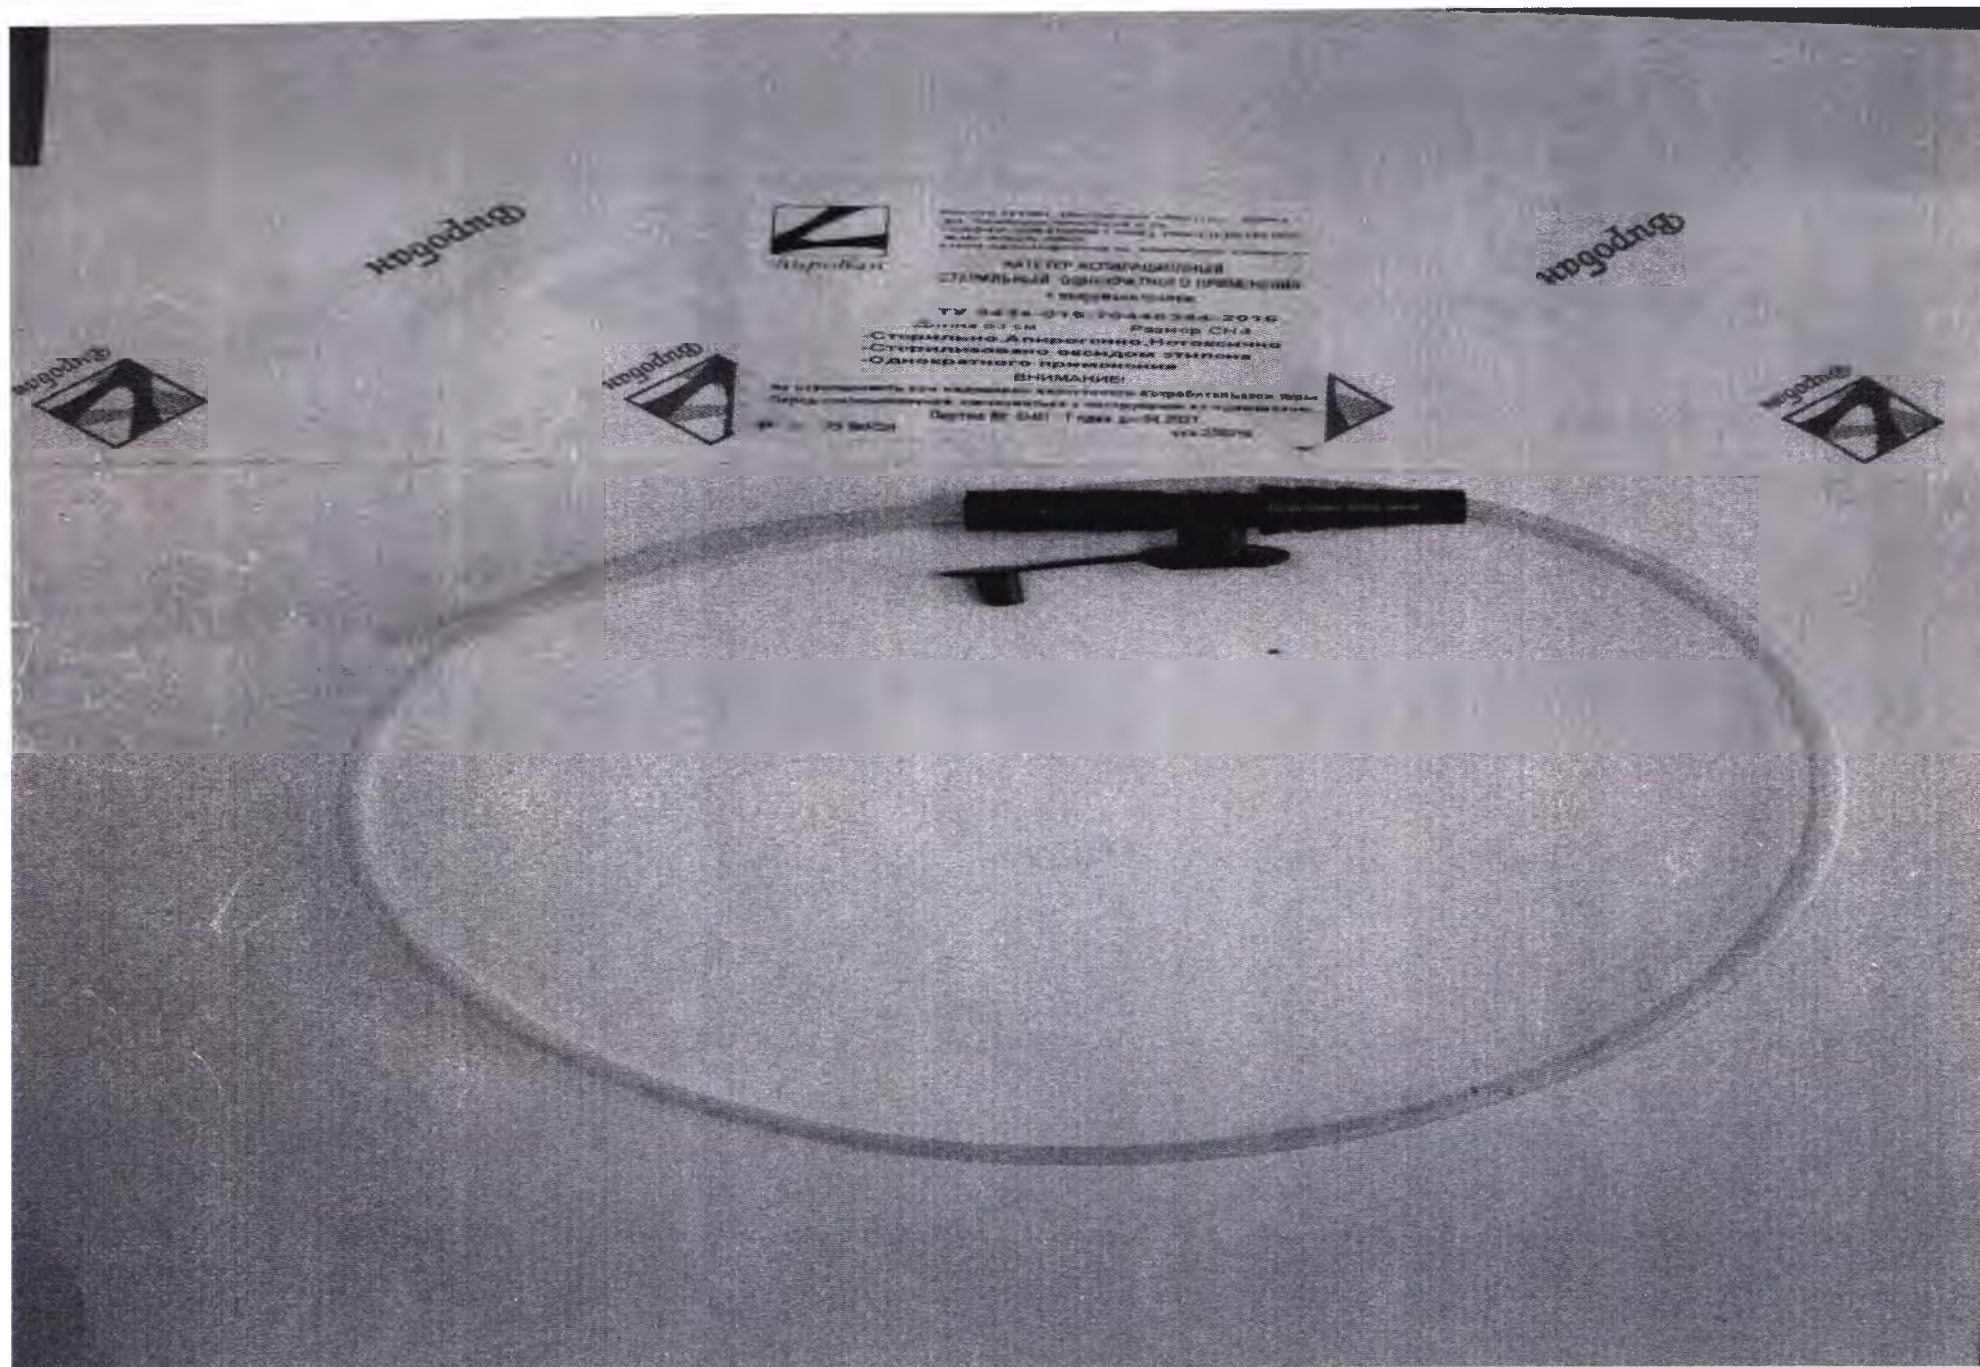

Маркировка потребительской тары Катетеры аспирационные стерильные однократного применения с вакуумконтролем СН4 ,длина 53 см по
ТУ 9436-015-70440344



Виробан

Россия, 141981, Московская область, г. Дубна
ул. Приборостроителей д.3а,
Тел/факс: (49621) 28861, 28862, 28863, (495) 745 7031,
Факс: (49621) 29022
e-mail: opinion@dubna.ru, <http://www.viroban.ru>

**КАТЕТЕР АСПИРАЦИОННЫЙ
СТЕРИЛЬНЫЙ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
с вакуумконтролем**

ТУ 9436-015-70440344-2016

Длина 53 см

Размер СН4

- Стерильно, Апиrogenно, Нетоксично**
- Стерилизовано оксидом этилена**
- Однократного применения**


ВНИМАНИЕ!

Не использовать при нарушении целостности потребительской тары.
Перед использованием ознакомиться с инструкцией по применению.

Партия №: 0-01 Годен до: 04.2021

РЗ РУ №РЗН

xxx-220316

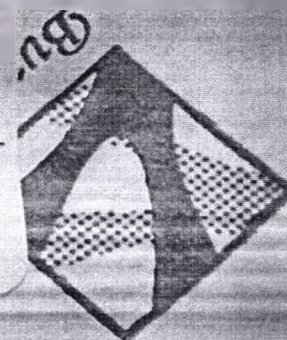




Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью ООО « Виробан»

21.08.2017 л.

Генеральный директор ООО « Виробан»


В.В. Николаев

В исполнении с вакуумконтролем CH5 длина 53 см

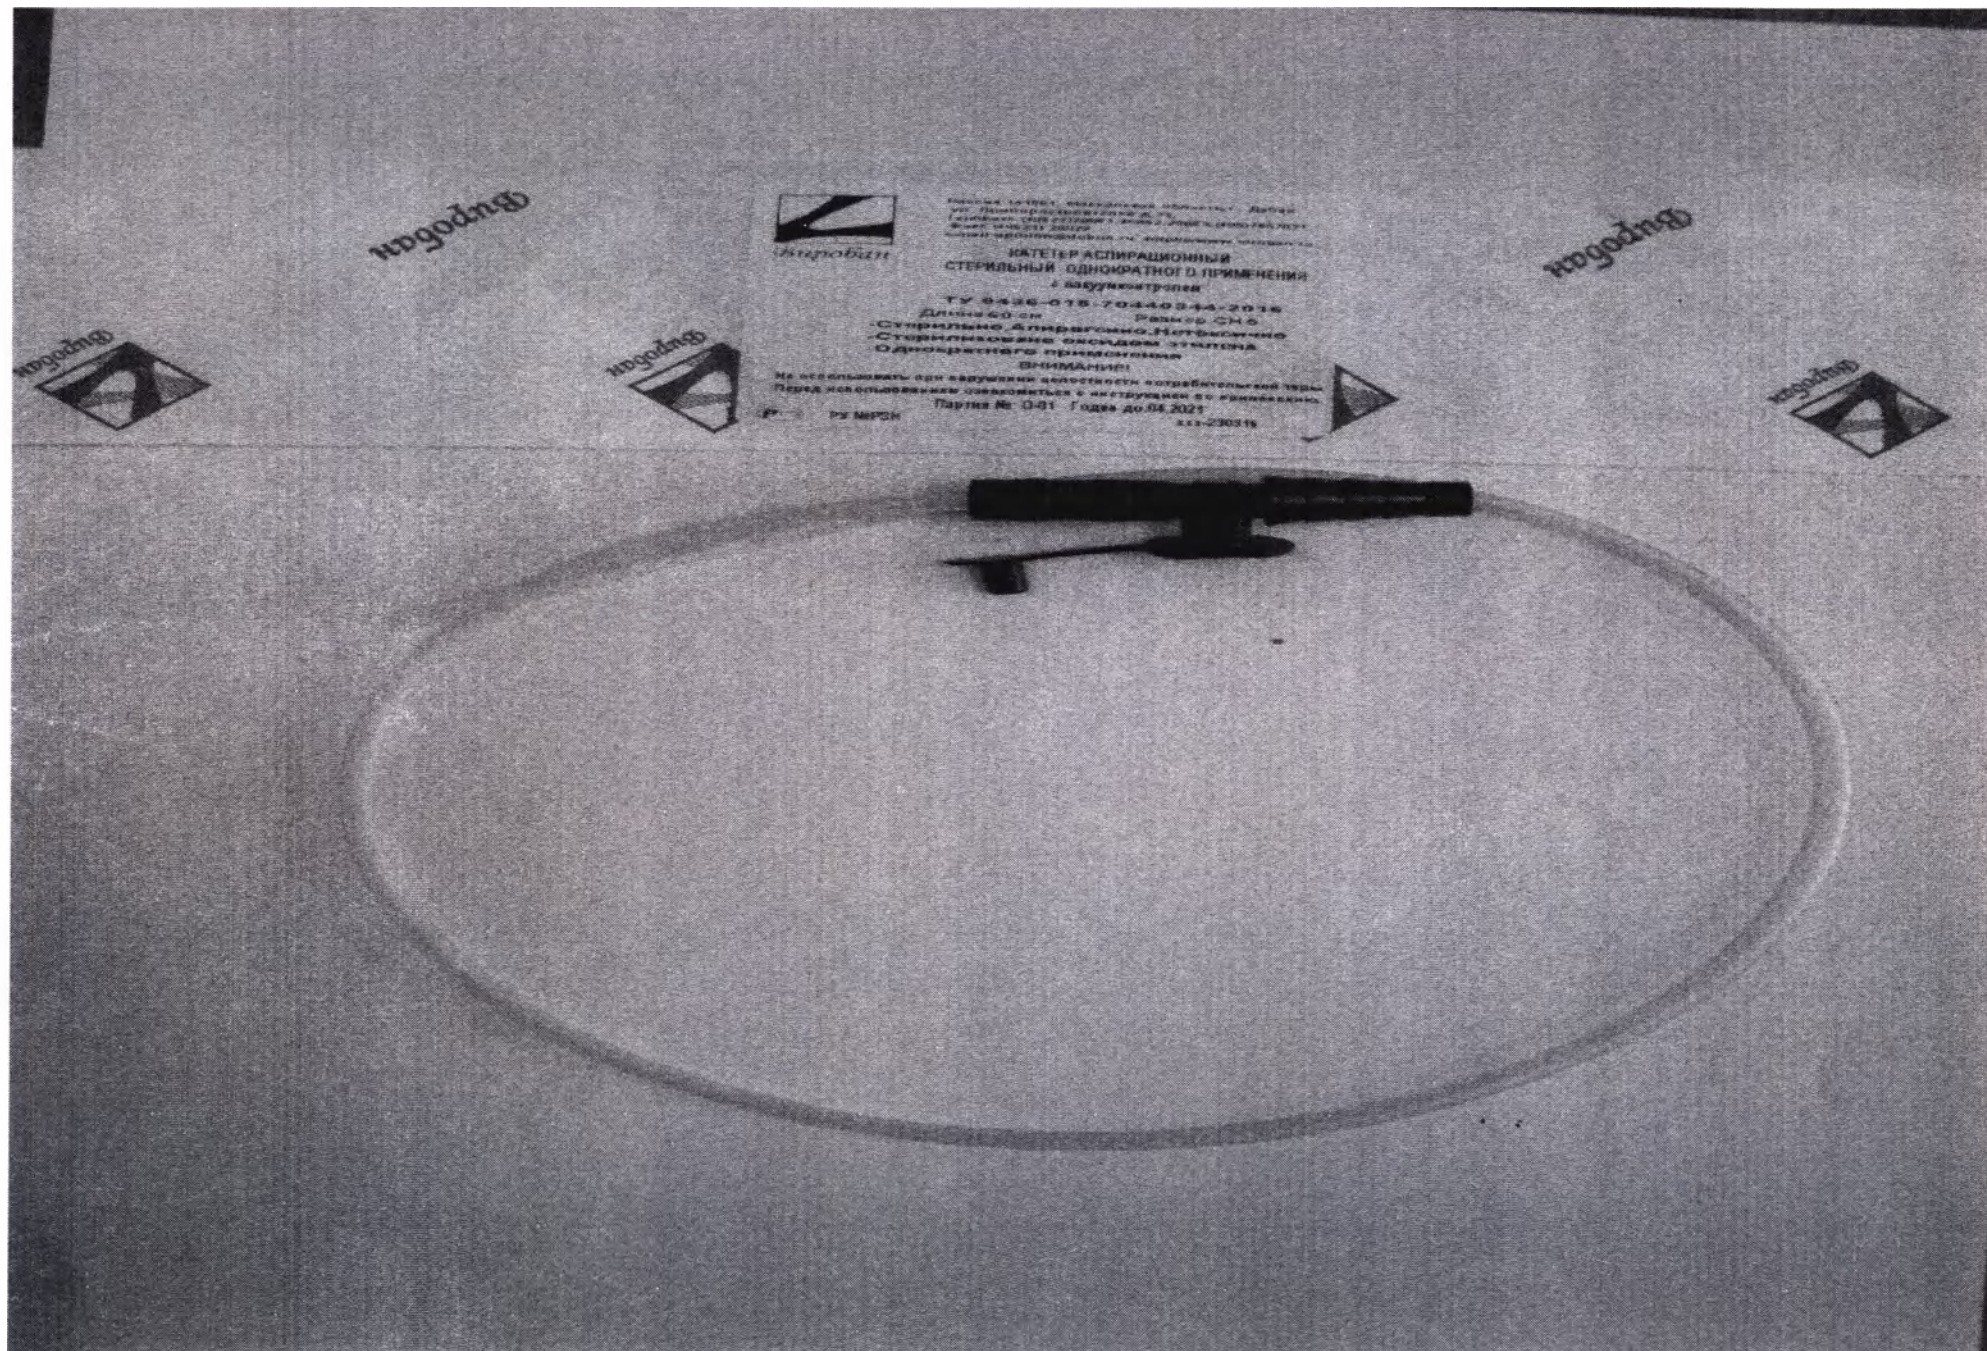

Маркировка потребительской тары Катетеры аспирационные стерильные однократного применения с вакуумконтролем CH5 ,длина 53 см по

ТУ 9436-015-70440344



Виробан

Россия, 141981, Московская область, г. Дубна
ул. Приборостроителей д.3а,
Тел/факс: (49621) 28861, 28862, 28863, (495) 7457031,
Факс: (49621) 29022
e-mail: opinion@dubna.ru, <http://www.viroban.ru>

**КАТЕТЕР АСПИРАЦИОННЫЙ
СТЕРИЛЬНЫЙ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
с вакуумконтролем**

ТУ 9436-015-70440344-2016

Длина 53 см Размер CH5

- Стерильно, Апиrogenно, Нетоксично**
- Стерилизовано оксидом этилена**
- Однократного применения**


ВНИМАНИЕ!

Не использовать при нарушении целостности потребительской тары.
Перед использованием ознакомиться с инструкцией по применению.

Партия №: 0-01 Годен до: 04.2021

Рос. РУ №РЗН

xxx-220316






Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью ООО « Виробан»

21.08.2017 л.


Генеральный директор ООО « Виробан»
В.В. Николаев



В исполнении с вакуумконтролем СН6 длина 53 см

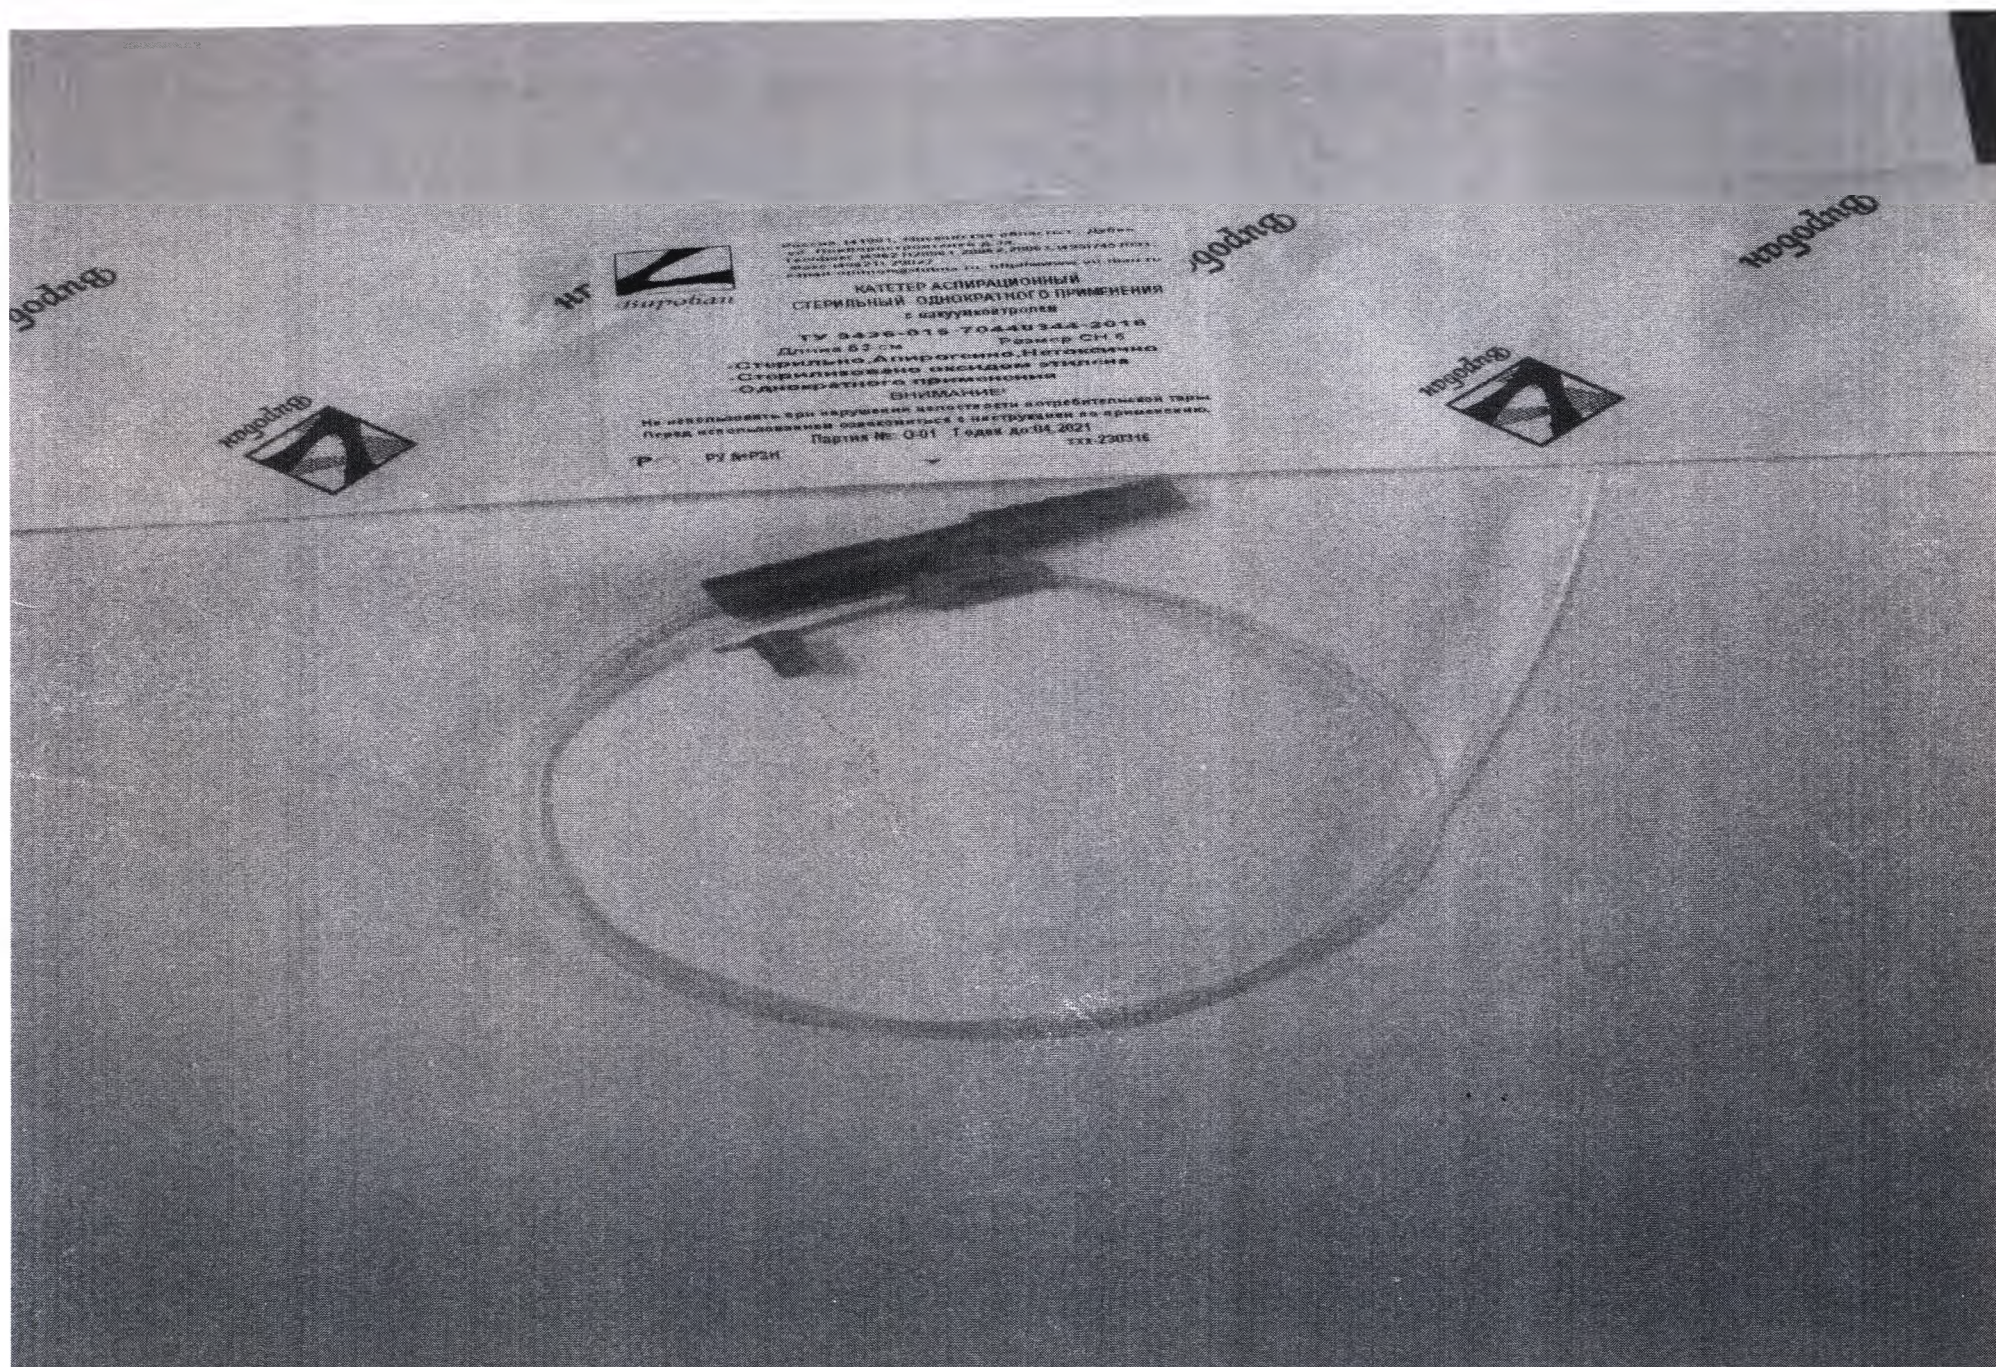

Маркировка потребительской тары Катетеры аспирационные стерильные однократного применения с вакуумконтролем СН6 ,длина 53 см по
ТУ 9436-015-70440344



Виробан

Россия, 141981, Московская область, г. Дубна
ул. Приблоростроителей д. 3а,
Тел/факс (49621) 23861, 23862, 23863, (495) 7457031
Факс (49621) 29022
e-mail: opinionon@dubna.ru, <http://www.viroban.ru>

**КАТЕТЕР АСПИРАЦИОННЫЙ
СТЕРИЛЬНЫЙ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
с вакуумконтролем**

ТУ 9436-015-70440344-2016

Длина 53 см Размер СН6

- Стерильно, Апиrogenно, Нетоксично**
- Стерилизовано оксидом этилена**
- Однократного применения**

ВНИМАНИЕ!

Не использовать при нарушении целостности потребительской тары.
Перед использованием ознакомиться с инструкцией по применению.

Партия №: 0-01 Годен до: 04.2021

РЗ РУ №РЗН

xxx-220316




Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью ООО « Виробан»

21.07.2017 л.

Генеральный директор ООО « Виробан»

В.В. Николаев

В исполнении с вакуумконтролем СН8 длина 53 см

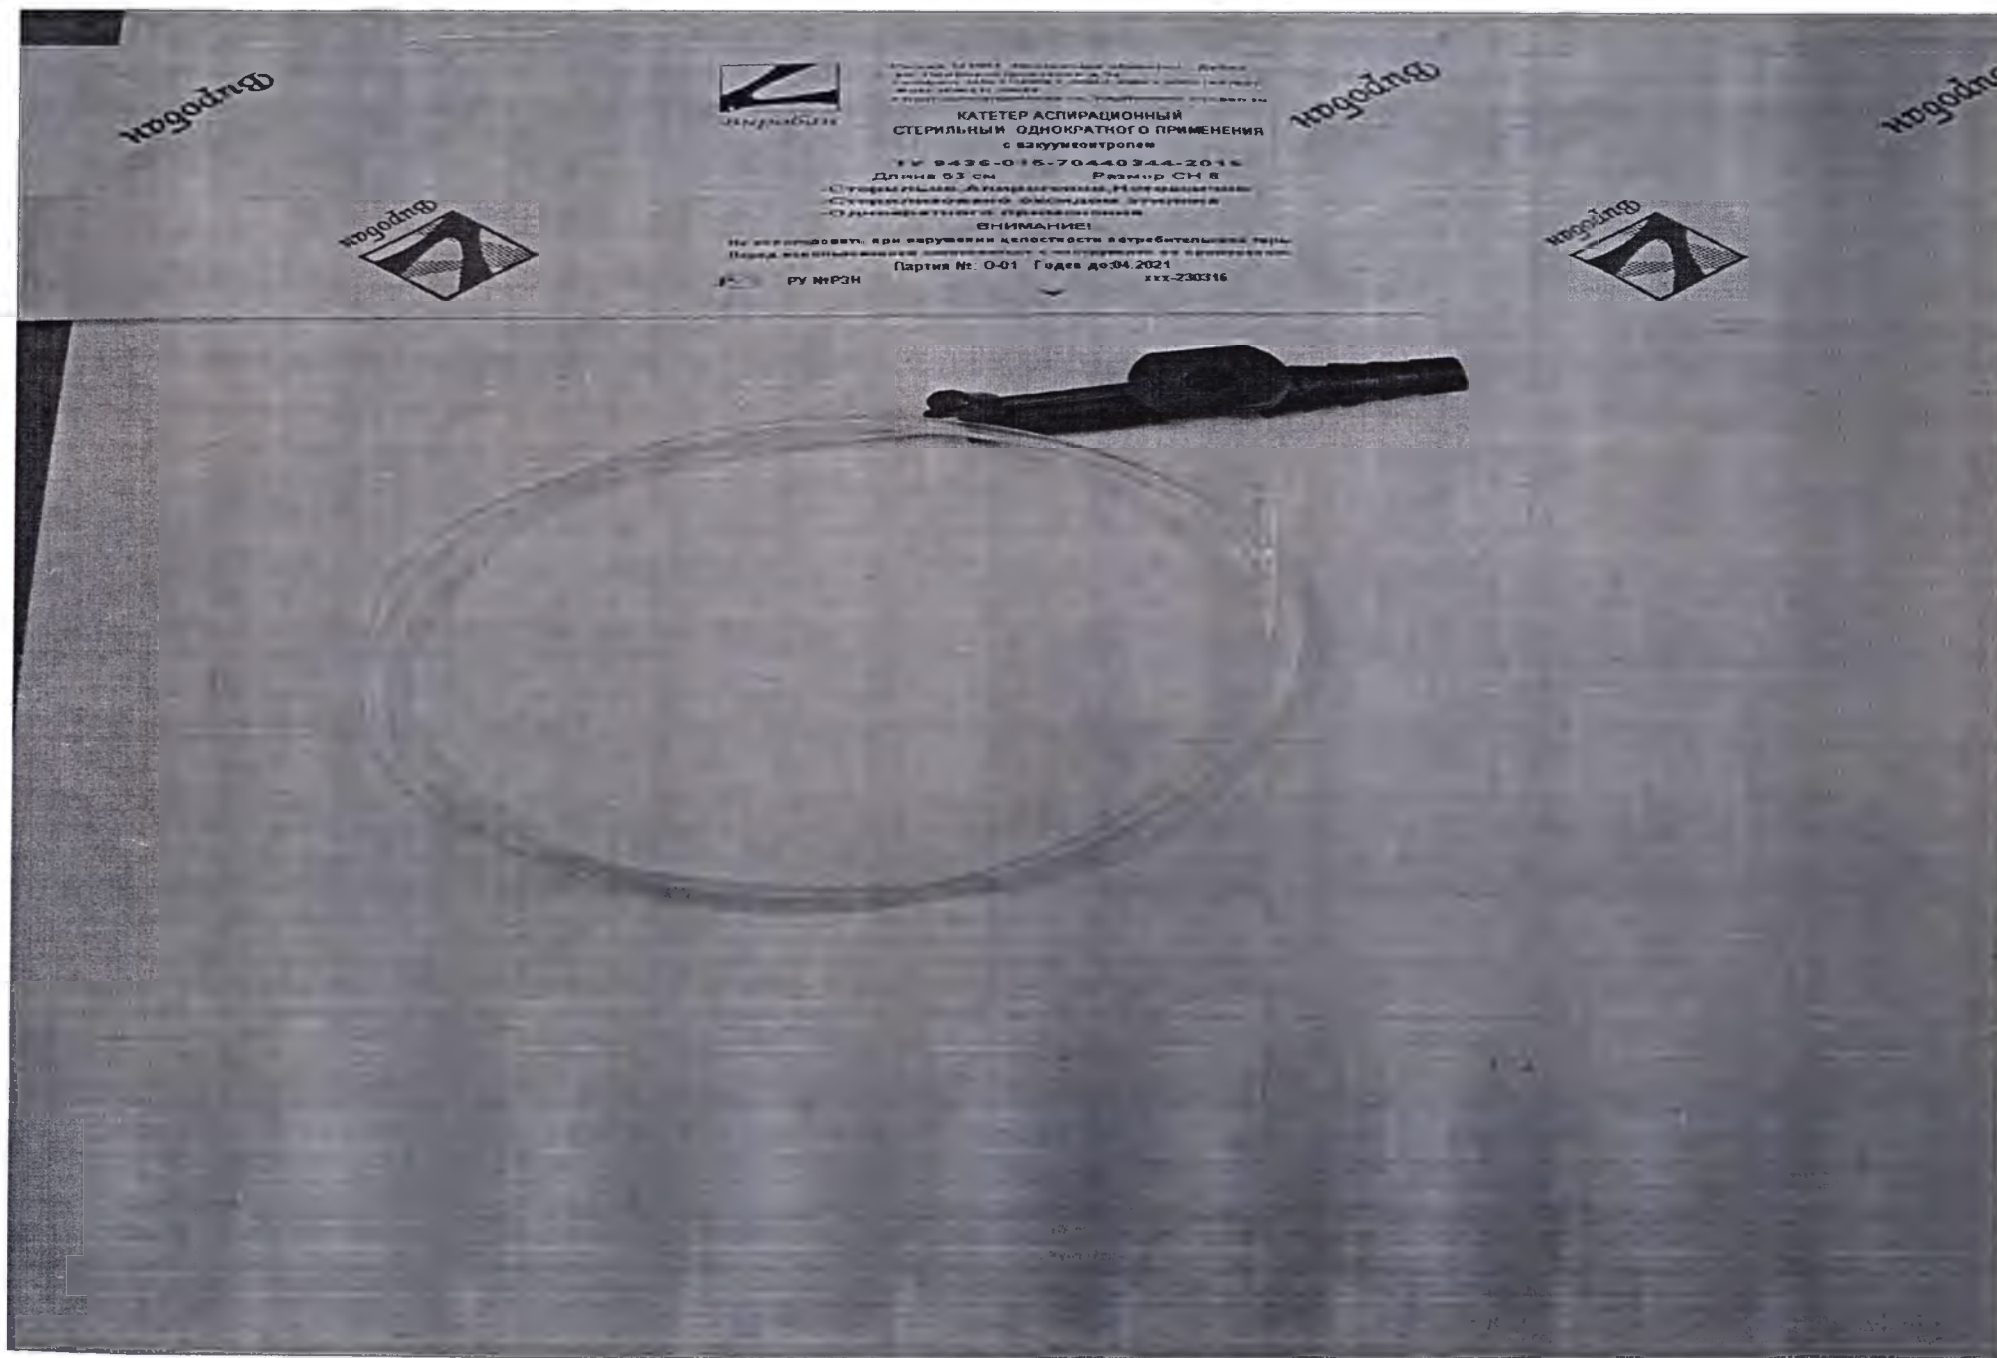



Виробан

Россия, 141981 Московская область, г. Дубна
ул. Приборостроителей д.3а,
Тел/факс (49621) 28861, 28862, 28863, (495) 7457031
Факс (49621) 29022
e-mail: opinion@dubna.ru, <http://www.viroban.ru>

**КАТЕТЕР АСПИРАЦИОННЫЙ
СТЕРИЛЬНЫЙ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ**

ТУ 9436-015-70440344-2016

Длина 53 см


Размер СН 8

- Стерильно, Апиrogenно, Нетоксично**
- Стерилизовано оксидом этилена**
- Однократного применения**

ВНИМАНИЕ!

Не использовать при нарушении целостности потребительской тары
Перед использованием ознакомиться с инструкцией по применению.

Партия №: О-01 Годен до: 04.2021



РУ №РЗН

xxx-230316




Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью ООО « Виробан»

21.08.2017 л.

Генеральный директор ООО « Виробан»

В.В. Николаев

В исполнении с вакуумконтролем СН10 длина 53 см

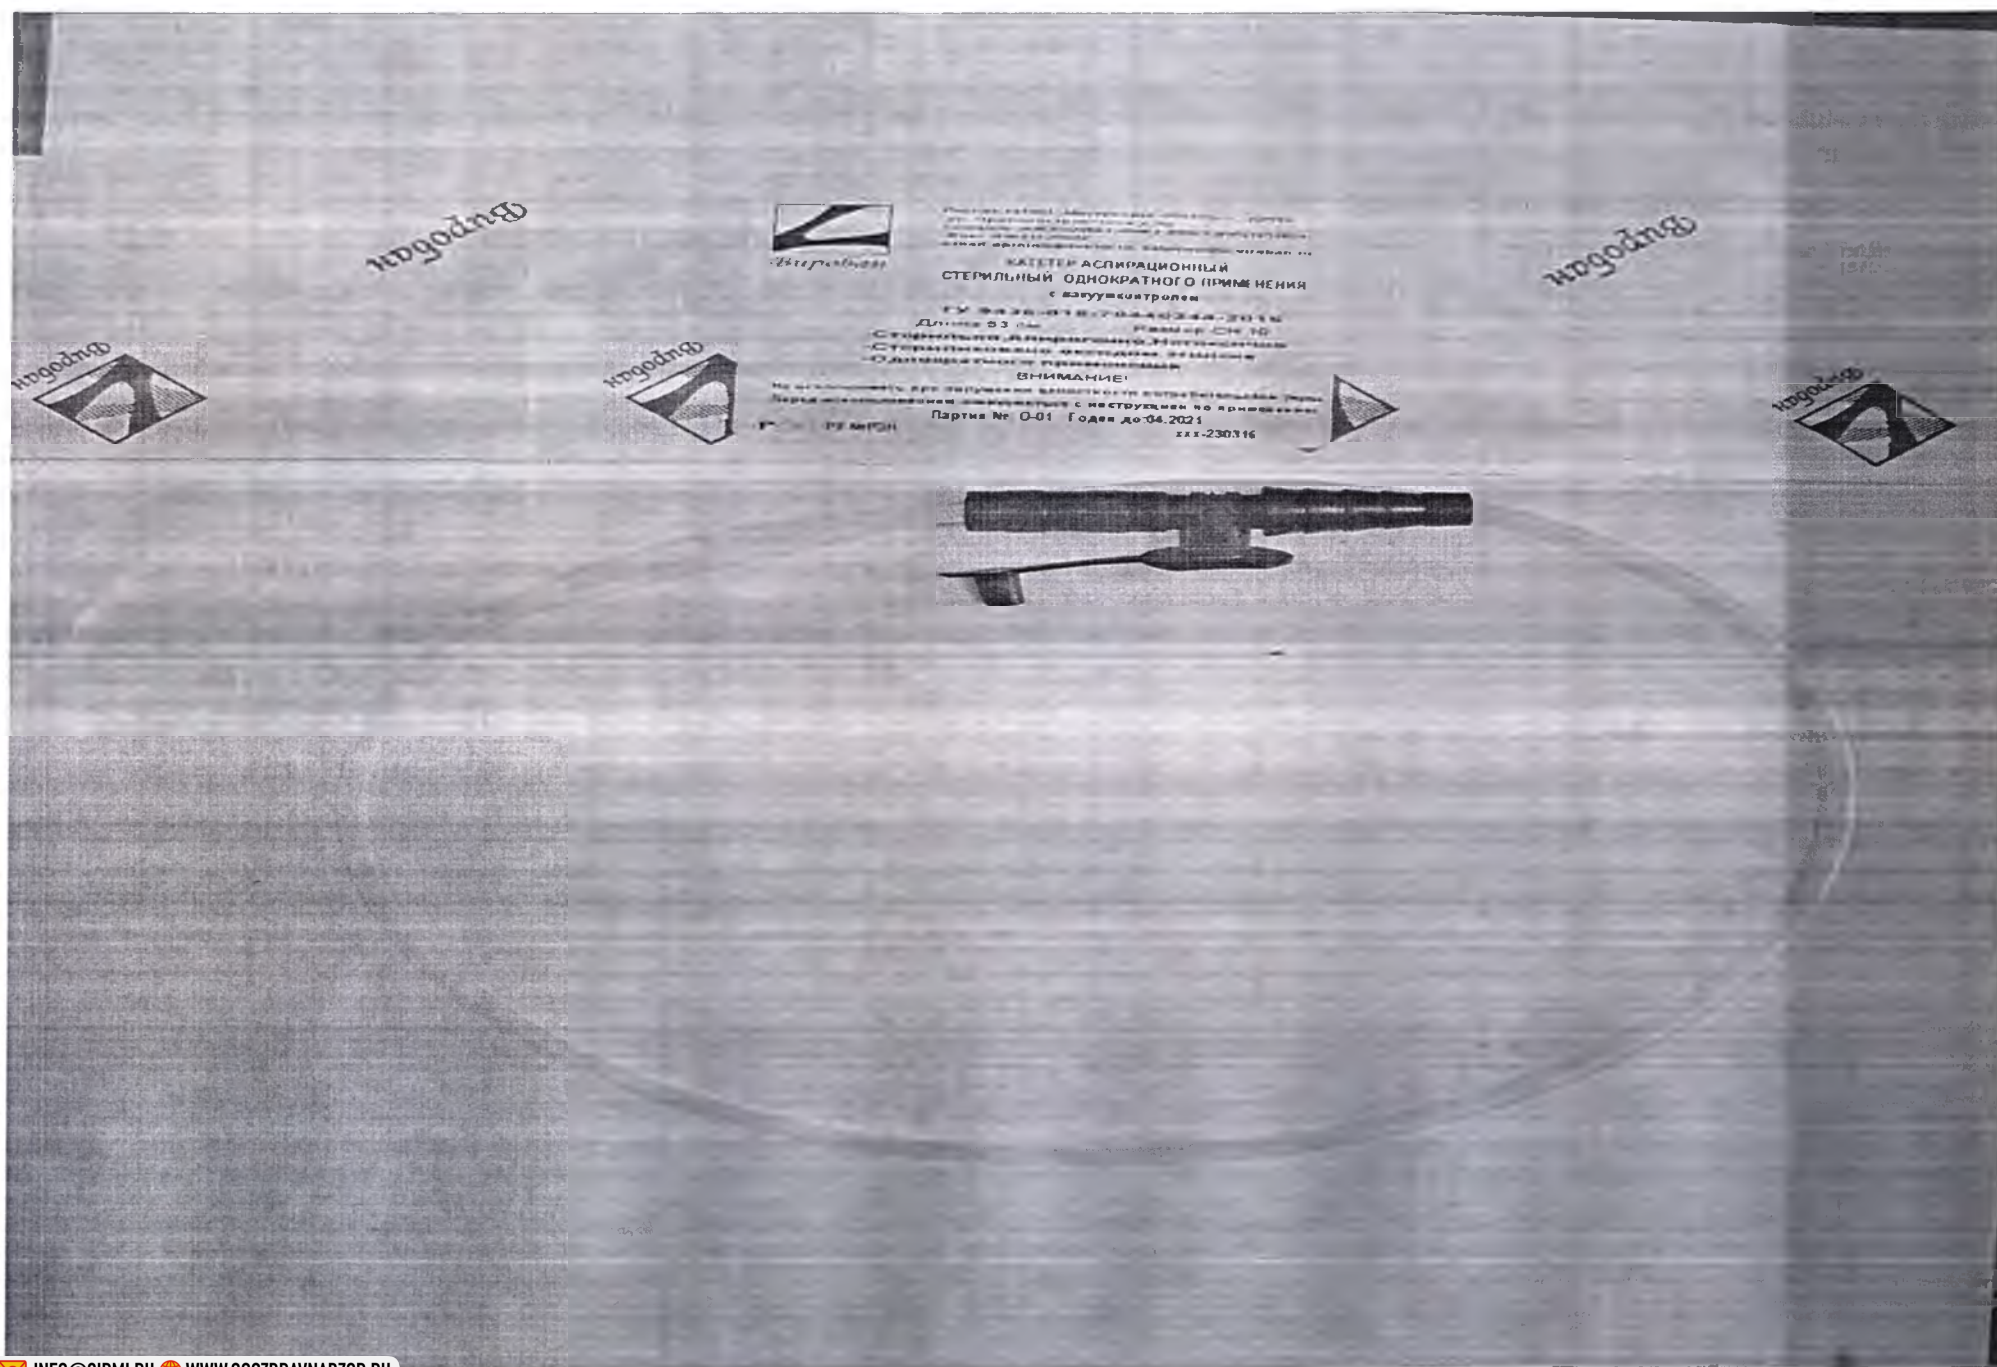

Маркировка потребительской тары Катетеры аспирационные стерильные однократного применения с вакуумконтролем СН10 ,длина 53 см по
ТУ 9436-015-70440344



Виробан

Россия 141981, Московская область, г. Дубна
ул. Приборостроителей д.3а,
Тел/факс: (49621) 28861, 28862, 28863, (495) 7457031,
Факс: (49621) 29022
e-mail: opinion@dubna.ru, <http://www.viroban.ru>

**КАТЕТЕР АСПИРАЦИОННЫЙ
СТЕРИЛЬНЫЙ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
с вакуумконтролем**

ТУ 9436-015-70440344-2016

Длина 53 см

Размер СН 10

- Стерильно, Апирогенно, Нетоксично**
- Стерилизовано оксидом этилена**
- Однократного применения**

ВНИМАНИЕ!

Не использовать при нарушении целостности потребительской тары.
Перед использованием ознакомиться с инструкцией по применению.

Партия №: 0-01 Годен до: 04.2021

Р... РУ №РЗН

xxx-230316



Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью ООО « Виробан»

21.08.2017 л.

Генеральный директор ООО « Виробан»
В.В. Николаев



Маркировка потребительской тары Катетеры аспирационные стерильные однократного применения с вакуумконтролем СН12, длина 53 см по
ТУ 9436-015-70440344



Виробан

Россия 141981, Московская область, г. Дубна
ул. Приборостроителей д. 3а,
Тел/факс (49621) 23861, 23863, (495) 7457031,
факс (49621) 29022
e-mail: opinion@dubna.ru, <http://www.viroban.ru>

**КАТЕТЕР АСПИРАЦИОННЫЙ
СТЕРИЛЬНЫЙ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
с вакуумконтролем**

ТУ 9436-015-70440344-2016

Длина 53 см, Размер СН 12

- Стерильно, Апирогенно, Нетоксично**
- Стерилизовано оксидом этилена**
- Однократного применения**

ВНИМАНИЕ!


Не использовать при нарушении целостности потребительской тары.
Перед использованием ознакомиться с инструкцией по применению.

Партия №: О-01 Годен до: 04.2021

РЗ РУ №РЗН

xxx-220316

В исполнении с вакуумконтролем CH12 длина 53 см

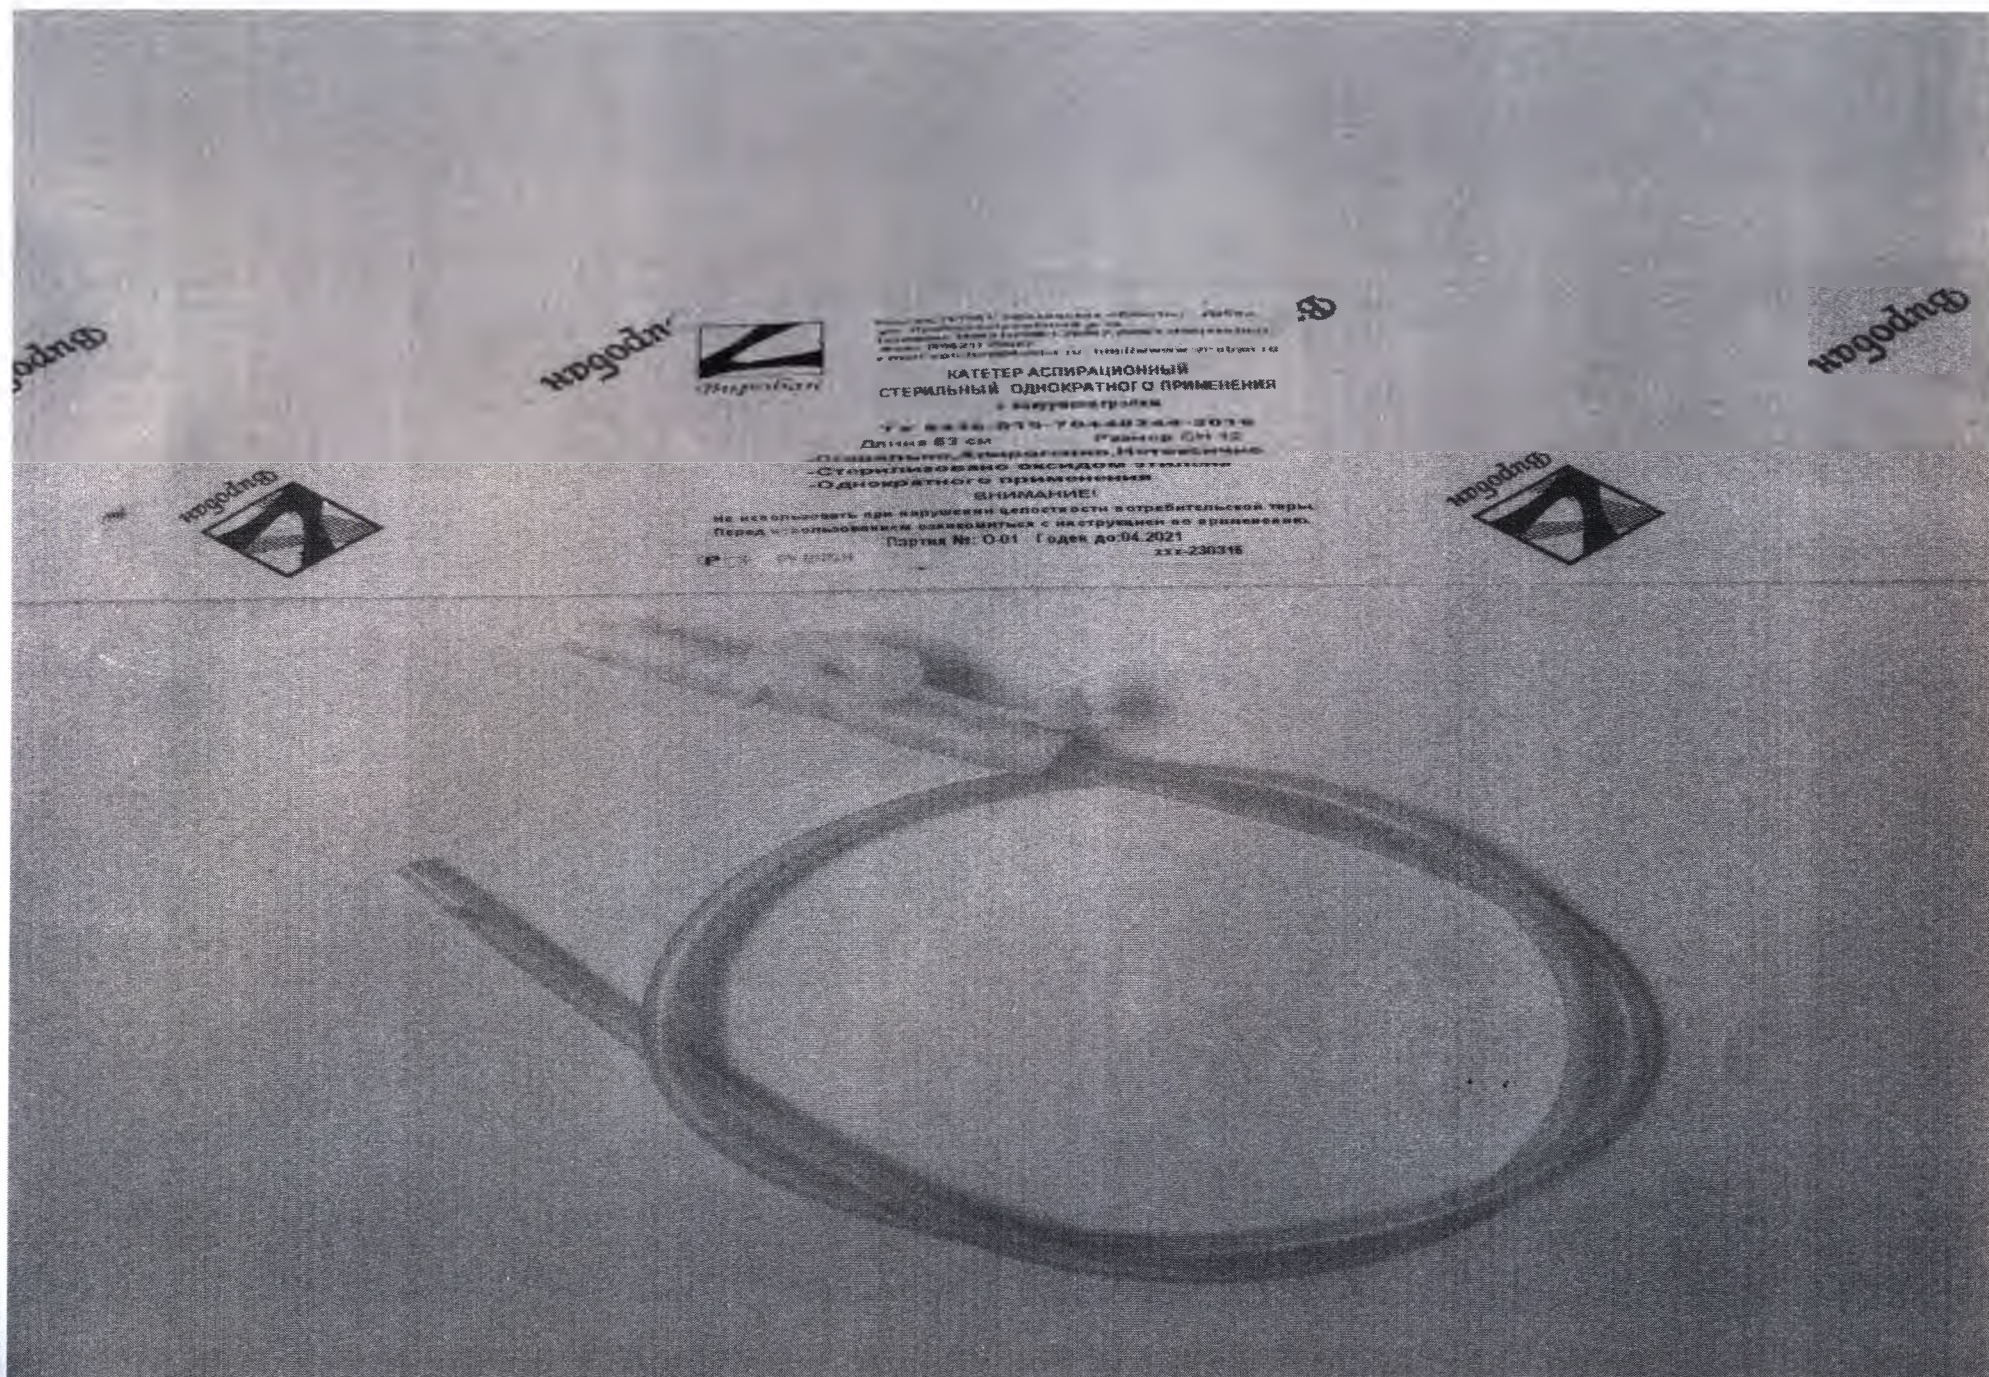




Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью ООО « Виробан»

21.08.2017 л.

Генеральный директор ООО « Виробан»
В.В. Николаев

В исполнении с вакуумконтролем СН14 длина 53 см

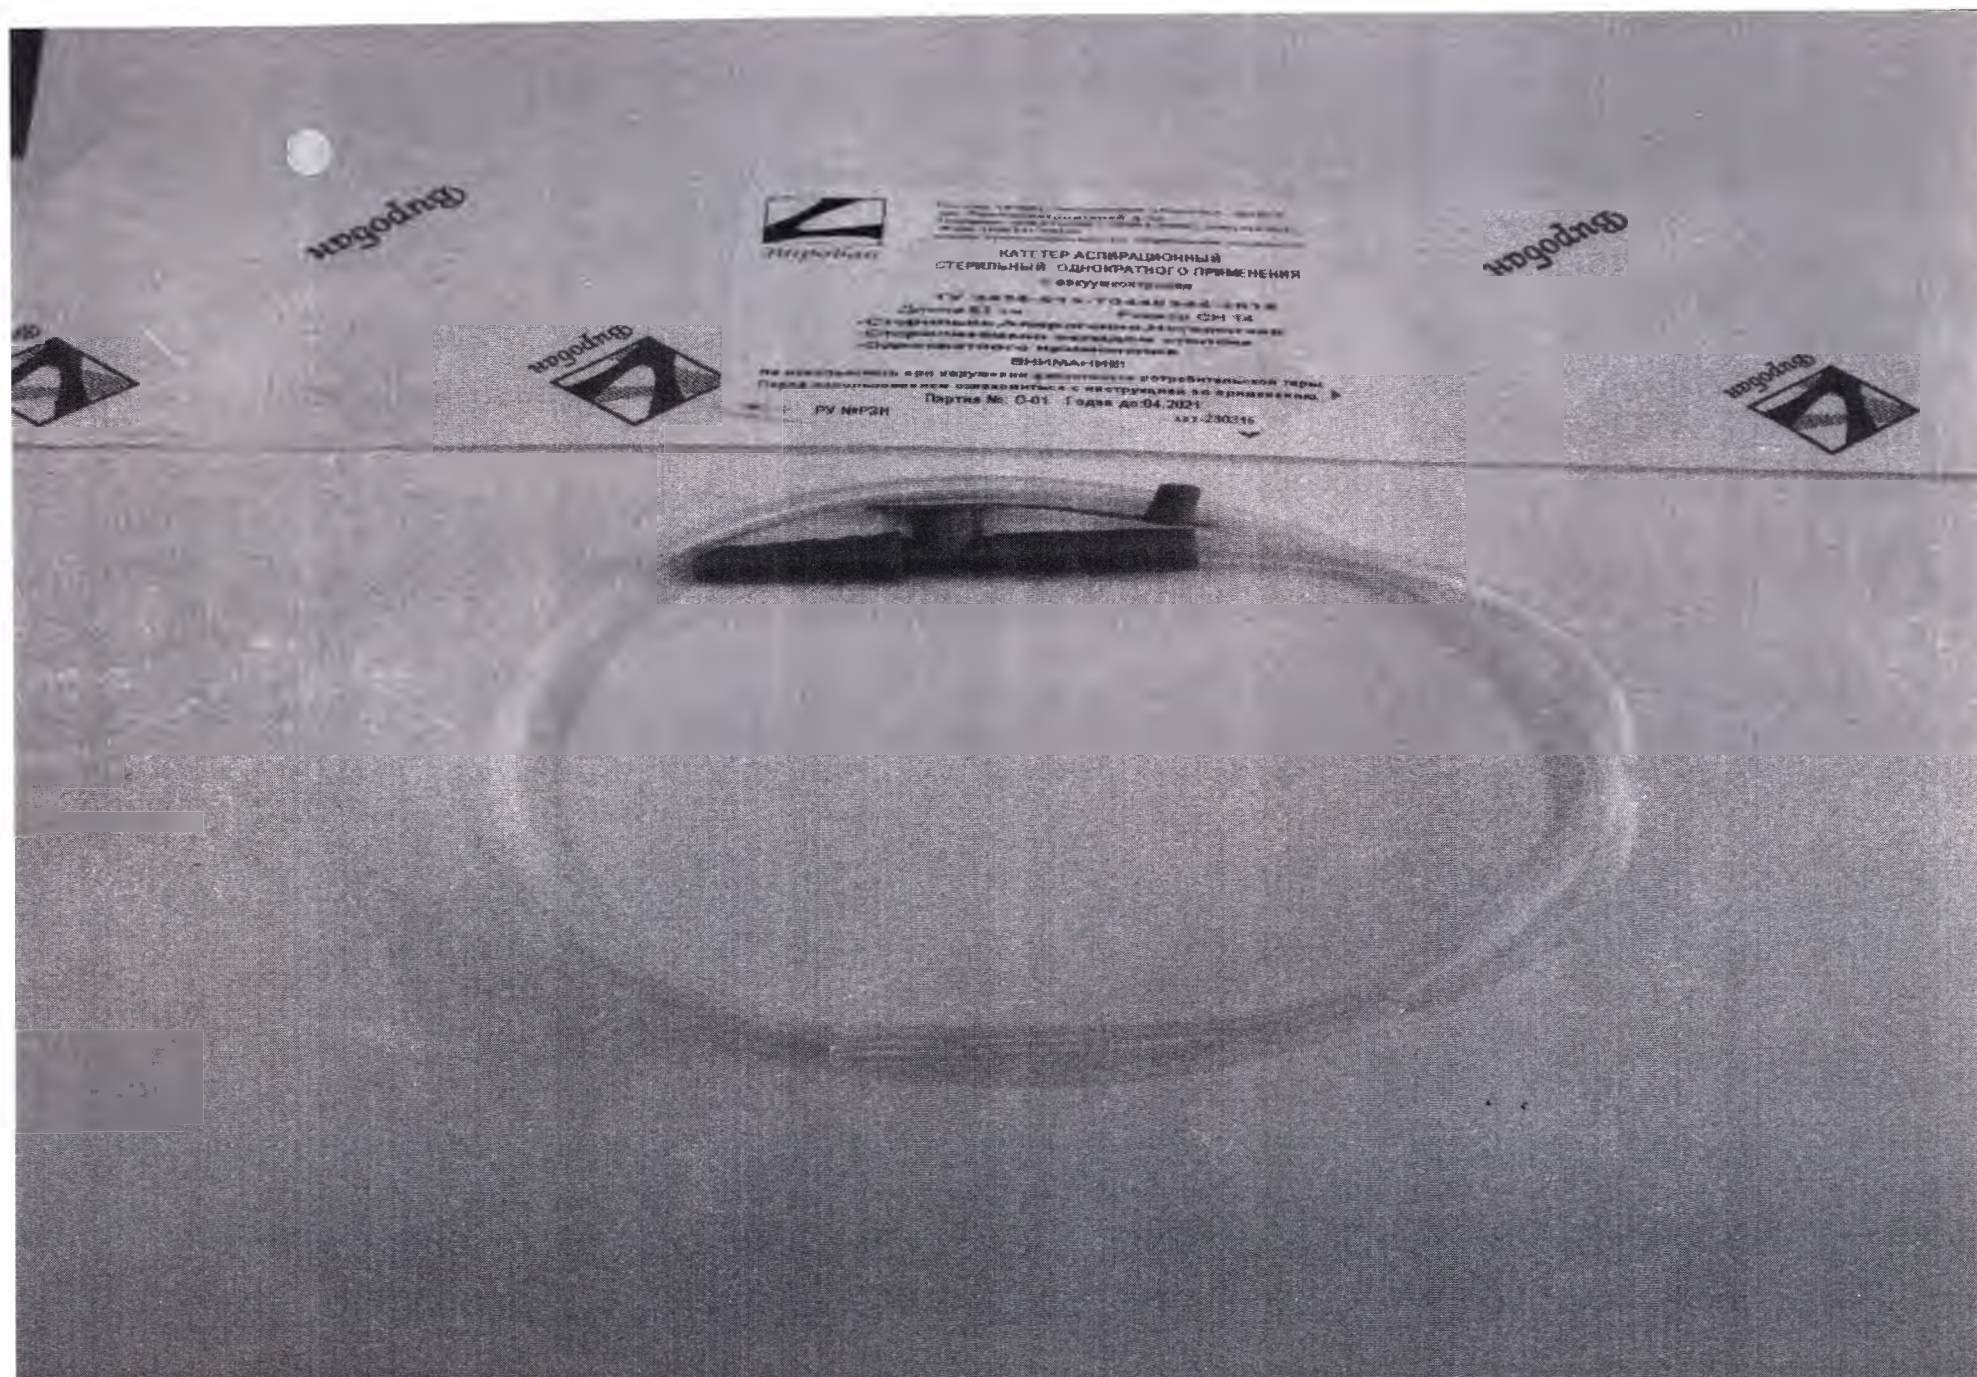



Виробан

Россия, 141981, Московская область, г. Дубна
уп. Приборостроителей д.3а,
Тел/факс: (49621) 23861, 23862, 23863, (495) 7457031,
Факс: (49621) 29022
e-mail: opinion@dubna.ru, <http://www.viroban.ru>

**КАТЕТЕР АСПИРАЦИОННЫЙ
СТЕРИЛЬНЫЙ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
с вакуумконтролем**

ТУ 9436-015-70440344-2016

Длина 53 см Размер СН 14

- Стерильно, Апиrogenно, Нетоксично**
- Стерилизовано оксидом этилена**
- Однократного применения**



ВНИМАНИЕ!

Не использовать при нарушении целостности потребительской тары.
Перед использованием ознакомиться с инструкцией по применению.

Партия №: 0-01 Годен до: 04.2021

Р РУ №РЗН

XXX-220316

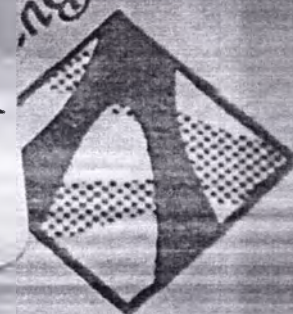




Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью ООО « Виробан»

21.08.2017 л.


Генеральный директор ООО « Виробан»
В.В. Николаев



В исполнении с вакуумконтролем СН16 длина 53 см

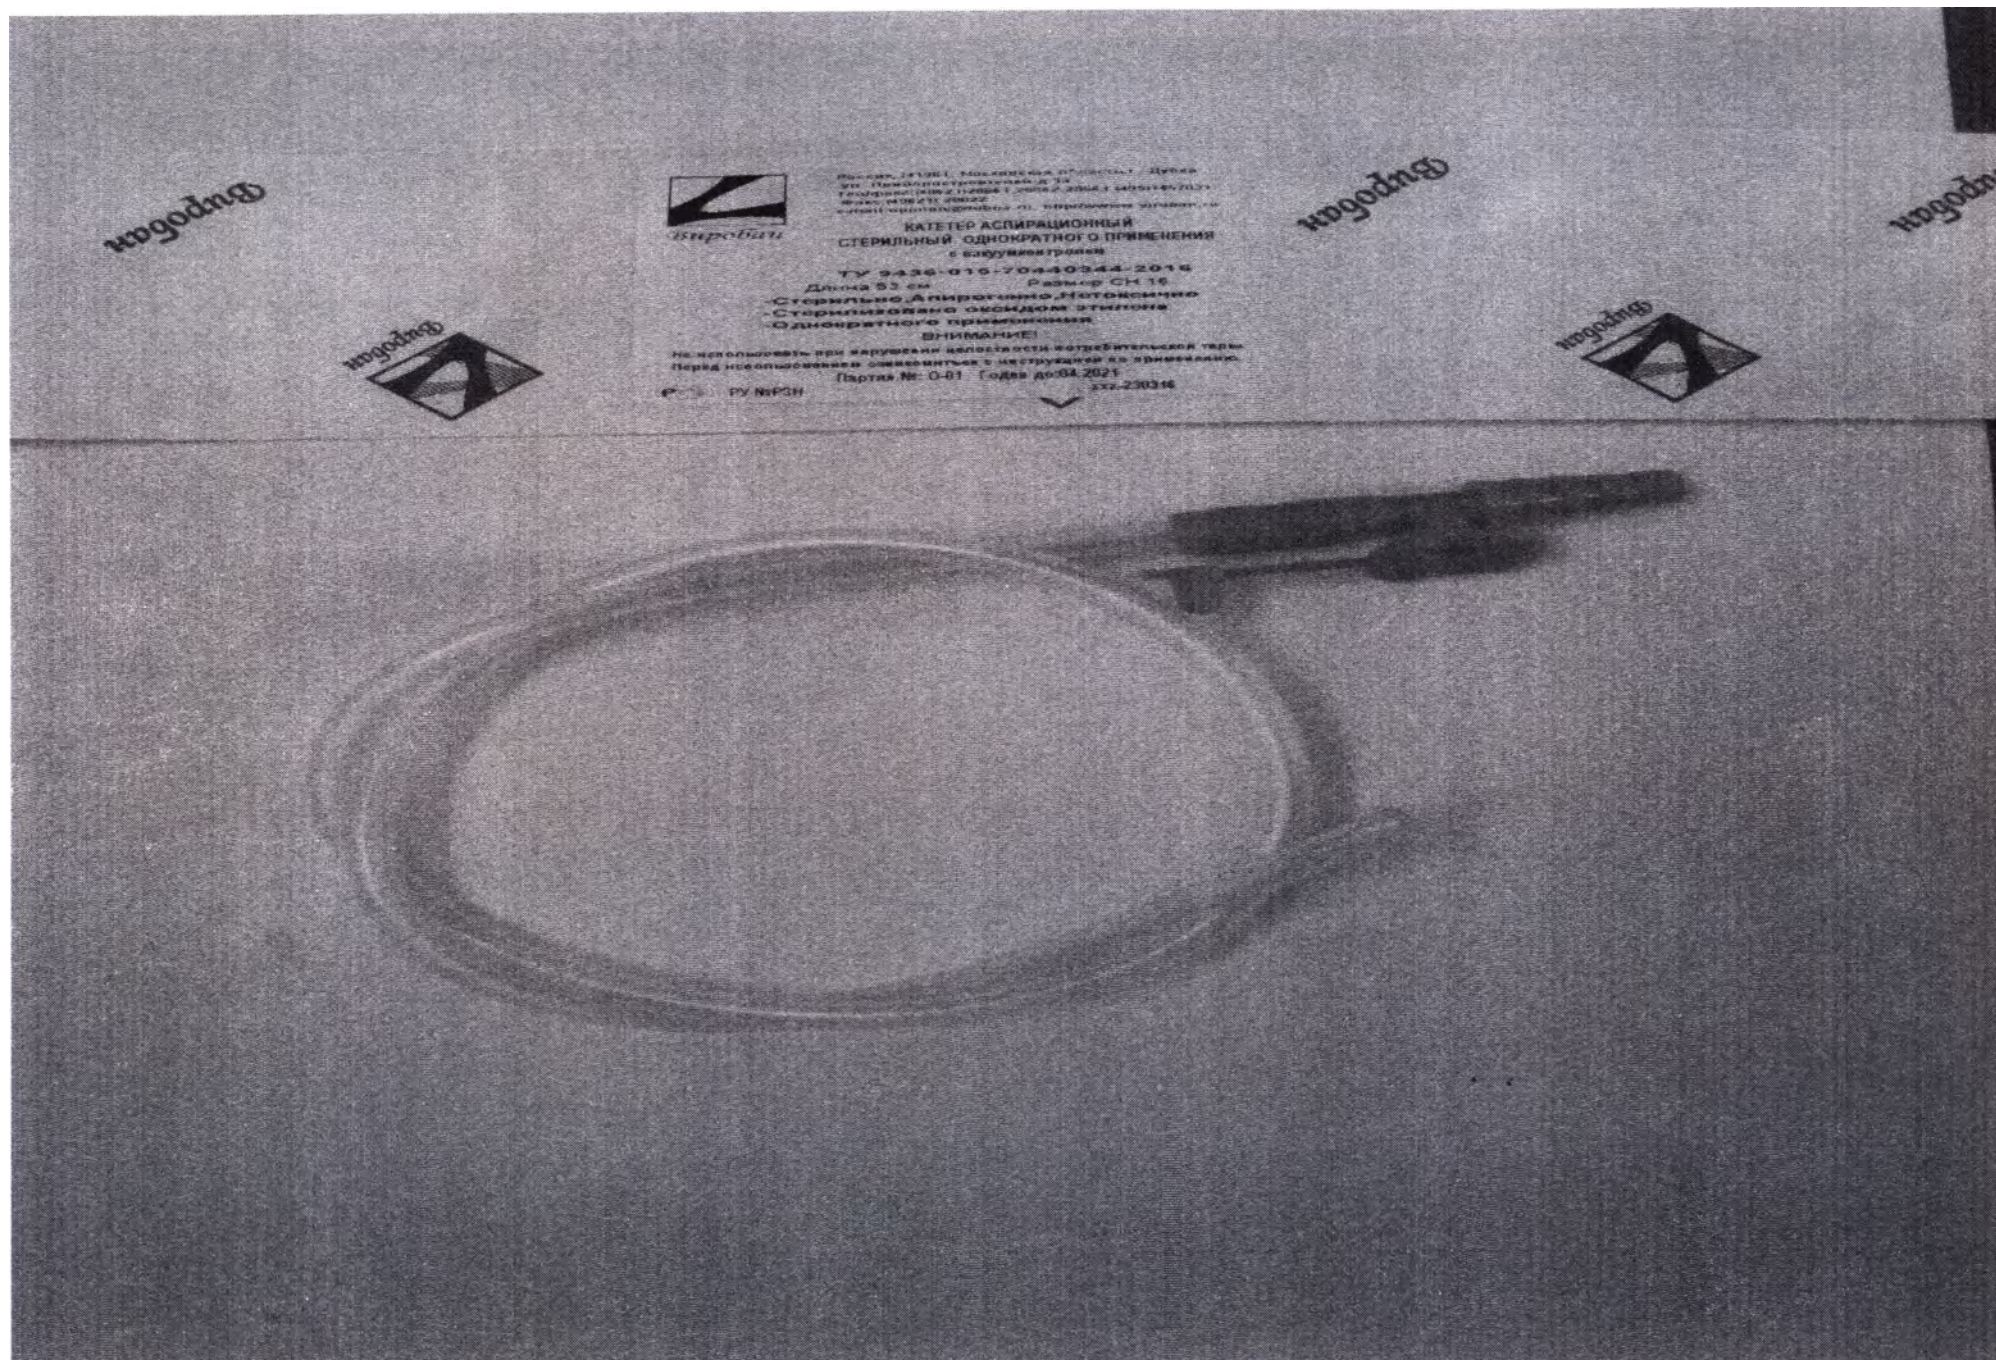

Маркировка потребительской тары Катетеры аспирационные стерильные однократного применения с вакуумконтролем СН16 ,длина 53 см по ТУ 9436-015-70440344-2016



Виробан

Россия, 141981, Московская область, г. Дубна
ул. Приборостроителей д.3а,
Тел/факс: (49621) 23861, 23862, 23863, (495) 7457031,
Факс (49621) 29022
e-mail: opinion@dubna.ru, <http://www.viroban.ru>

**КАТЕТЕР АСПИРАЦИОННЫЙ
СТЕРИЛЬНЫЙ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
с вакуумконтролем**

ТУ 9436-015-70440344-2016

Длина 53 см

Размер СН 16

- Стерильно, Апирогенно, Нетоксично
- Стерилизовано оксидом этилена
- Однократного применения

ВНИМАНИЕ!

Не использовать при нарушении целостности потребительской тары.
Перед использованием ознакомиться с инструкцией по применению.

Партия №: О-01 Годен до: 04.2021

Р... РУ №РЗН

xxx-230316



Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью ООО « Виробан»

21.08.2017 л.

Генеральный директор ООО « Виробан»

В.В. Николаев

Рисунки 141981. Московская область, г. Дубна.
УП. Приборостроительный ДЗ.
Тел.: 408 2110016, 408062, 20063, 4081240, 2031.
Факс: 408 211 20032.
e-mail: info@viroban.ru, <http://www.viroban.ru>

**КАТЕТЕР АСПИРАЦИОННЫЙ
СТЕРИЛЬНЫЙ ОДИОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
с вакуумконтролем**

ТУ 3436-016-70440344-2016
Длина 53 см Размер СН 18


Стерильно, Асепотично, Нестовсимо
Стерилизовано оксидом этилена
Однократного применения

ВНИМАНИЕ!
Не использовать при нарушении целостности потребительской тары.
Перед использованием ознакомиться с инструкцией по применению.

Партия № 0-01. Годен до 04.2021

РУ №РЭН XXX-23034

Маркировка потребительской тары Катетеры аспирационные стерильные однократного применения с вакуумконтролем СН18 ,длина 53 см по ТУ 9436-015-70440344-2016



Виробан

Россия, 141981, Московская область, Дубна
ул. Приборостроителей д.3а,
Тел/факс: (49621) 28661, 28662, 28663, (495) 745 7031
Факс: (49621) 29022
e-mail: orinon@dubna.ru, <http://www.viroban.ru>

**КАТЕТЕР АСПИРАЦИОННЫЙ
СТЕРИЛЬНЫЙ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
с вакуумконтролем**

ТУ 9436-015-70440344-2016

Длина 53 см

Размер СН 18

- Стерильно, Апиrogenно, Нетоксично**
- Стерилизовано оксидом этилена**
- Однократного применения**


ВНИМАНИЕ!

Не использовать при нарушении целостности потребительской тары.
Перед использованием ознакомиться с инструкцией по применению.

Партия №: О-01 Годен до: 04.2021

(P) РУ №РЗН

xxx-230316

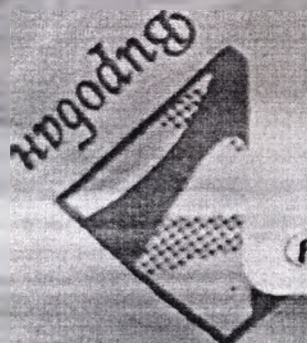




Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью ООО « Виробан»

21.08.2017 л.


Генеральный директор ООО « Виробан»
В.В. Николаев



В исполнении с вакуумконтролем CH20 длина 53 см

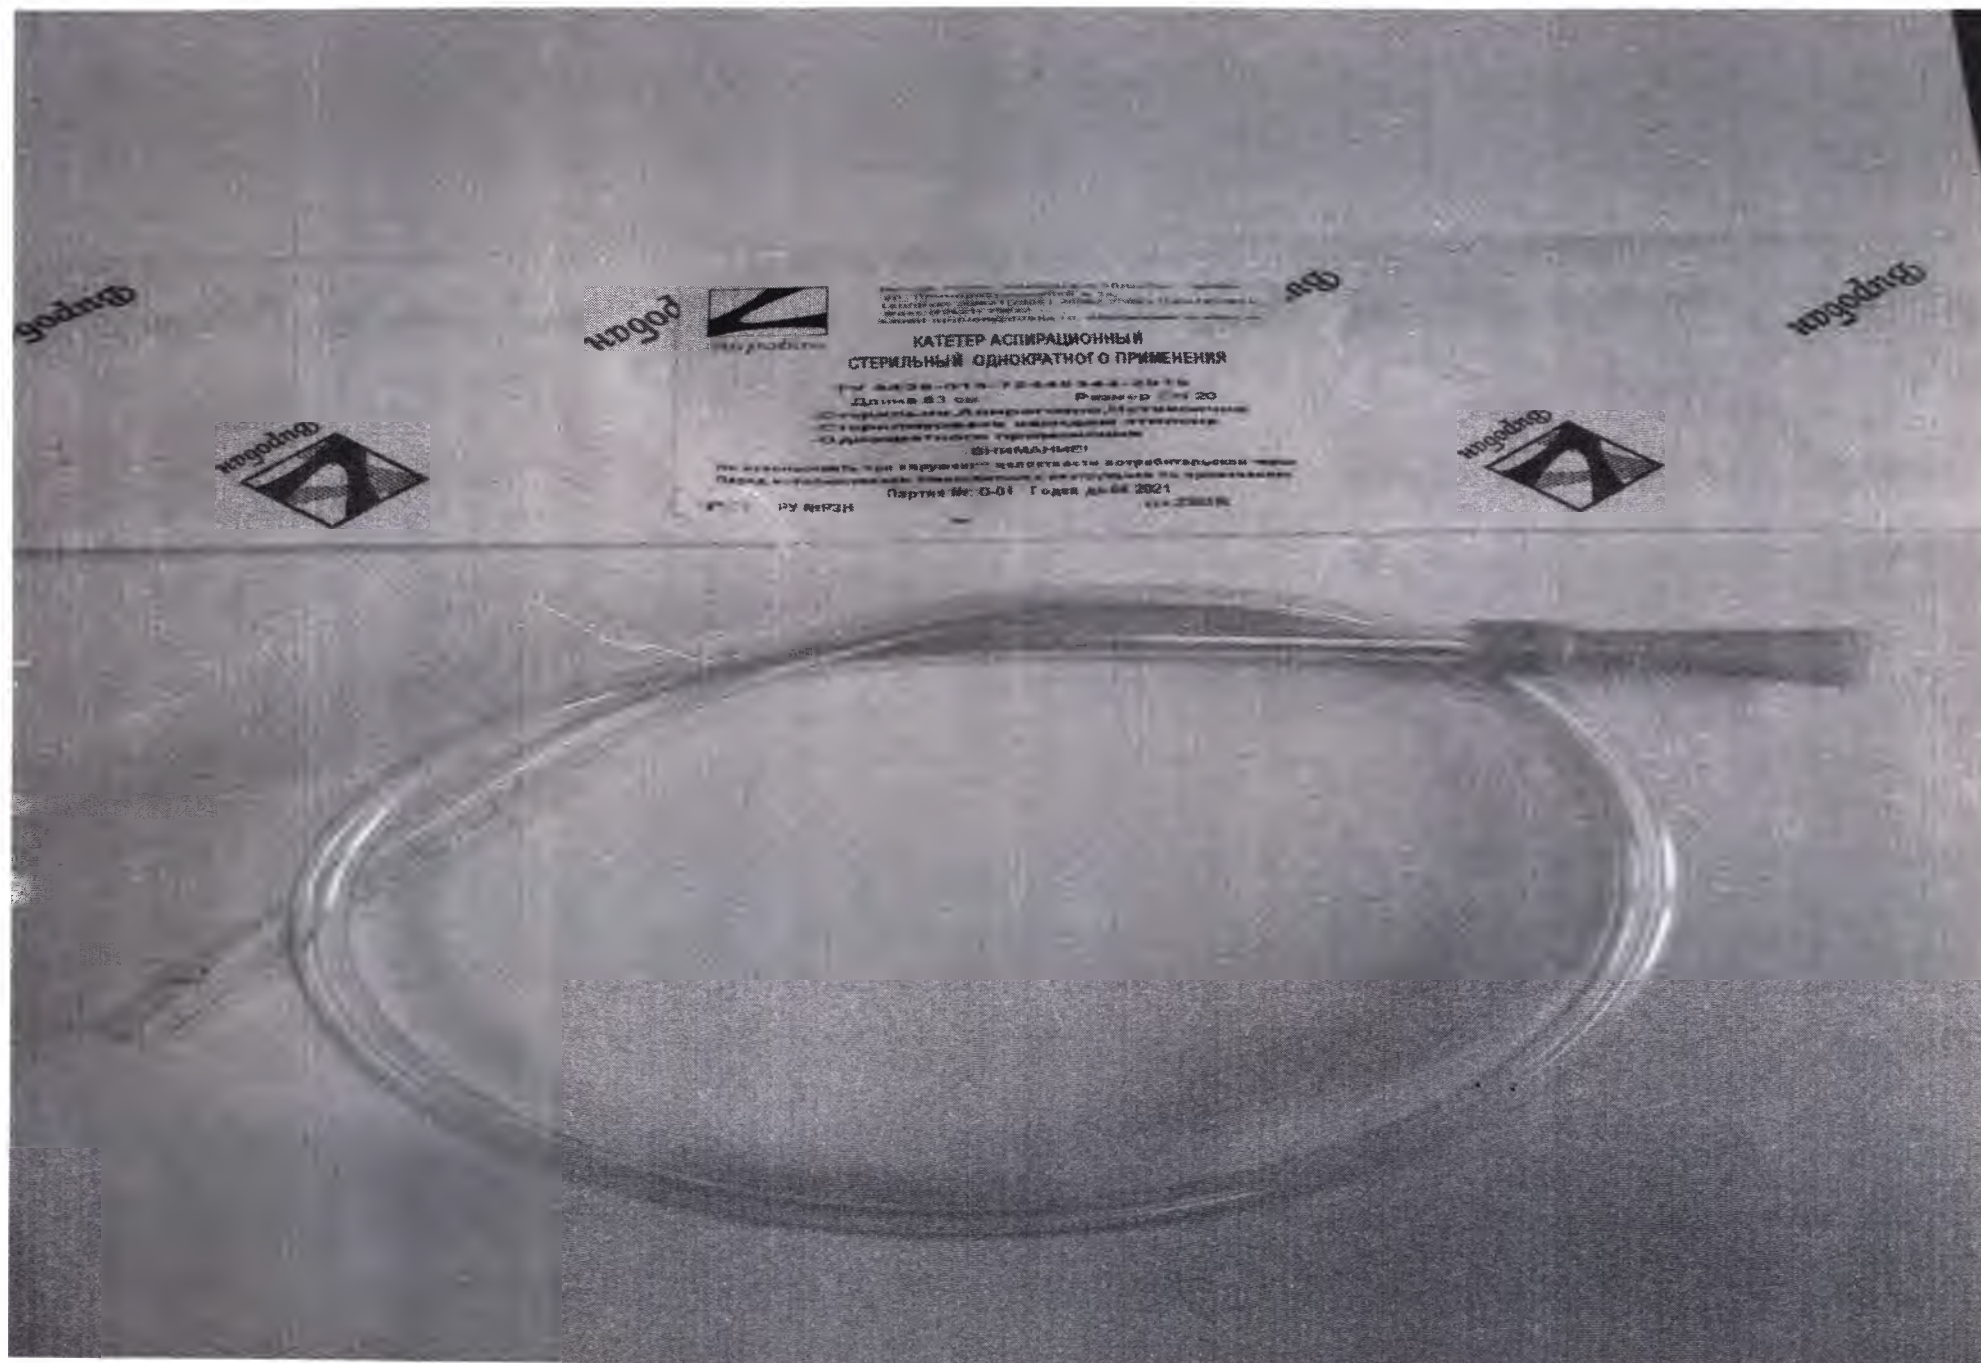

Маркировка потребительской тары Катетеры аспирационные стерильные однократного применения с вакуумконтролем СН20, длина 53 см по ТУ 9436-015-70440344-2016



Виробан

Россия, 141981, Московская область, г. Дубна
ул. Приборостроителей д.3а,
Тел/факс: (49621) 23861, 23862, 23863, (495) 745 7031
Факс: (49621) 29022
e-mail: opinion@dubna.ru, <http://www.viroban.ru>

**КАТЕТЕР АСПИРАЦИОННЫЙ
СТЕРИЛЬНЫЙ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
с вакуумконтролем**

ТУ 9436-015-70440344-2016

Длина 53 см

Размер СН20

- Стерильно, Апирогенно, Нетоксично**
- Стерилизовано оксидом этилена**
- Однократного применения**

ВНИМАНИЕ!


Не использовать при нарушении целостности потребительской тары.
Перед использованием ознакомиться с инструкцией по применению.

Партия №: О-01 Годен до: 04.2021



РУ №РЗН

xxx-230316

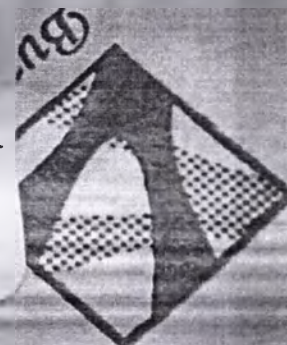




Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью ООО « Виробан»

21.08.2017 л.

Генеральный директор ООО « Виробан»
В.В. Николаев



В исполнении с вакуумконтролем CH22 длина 53 см

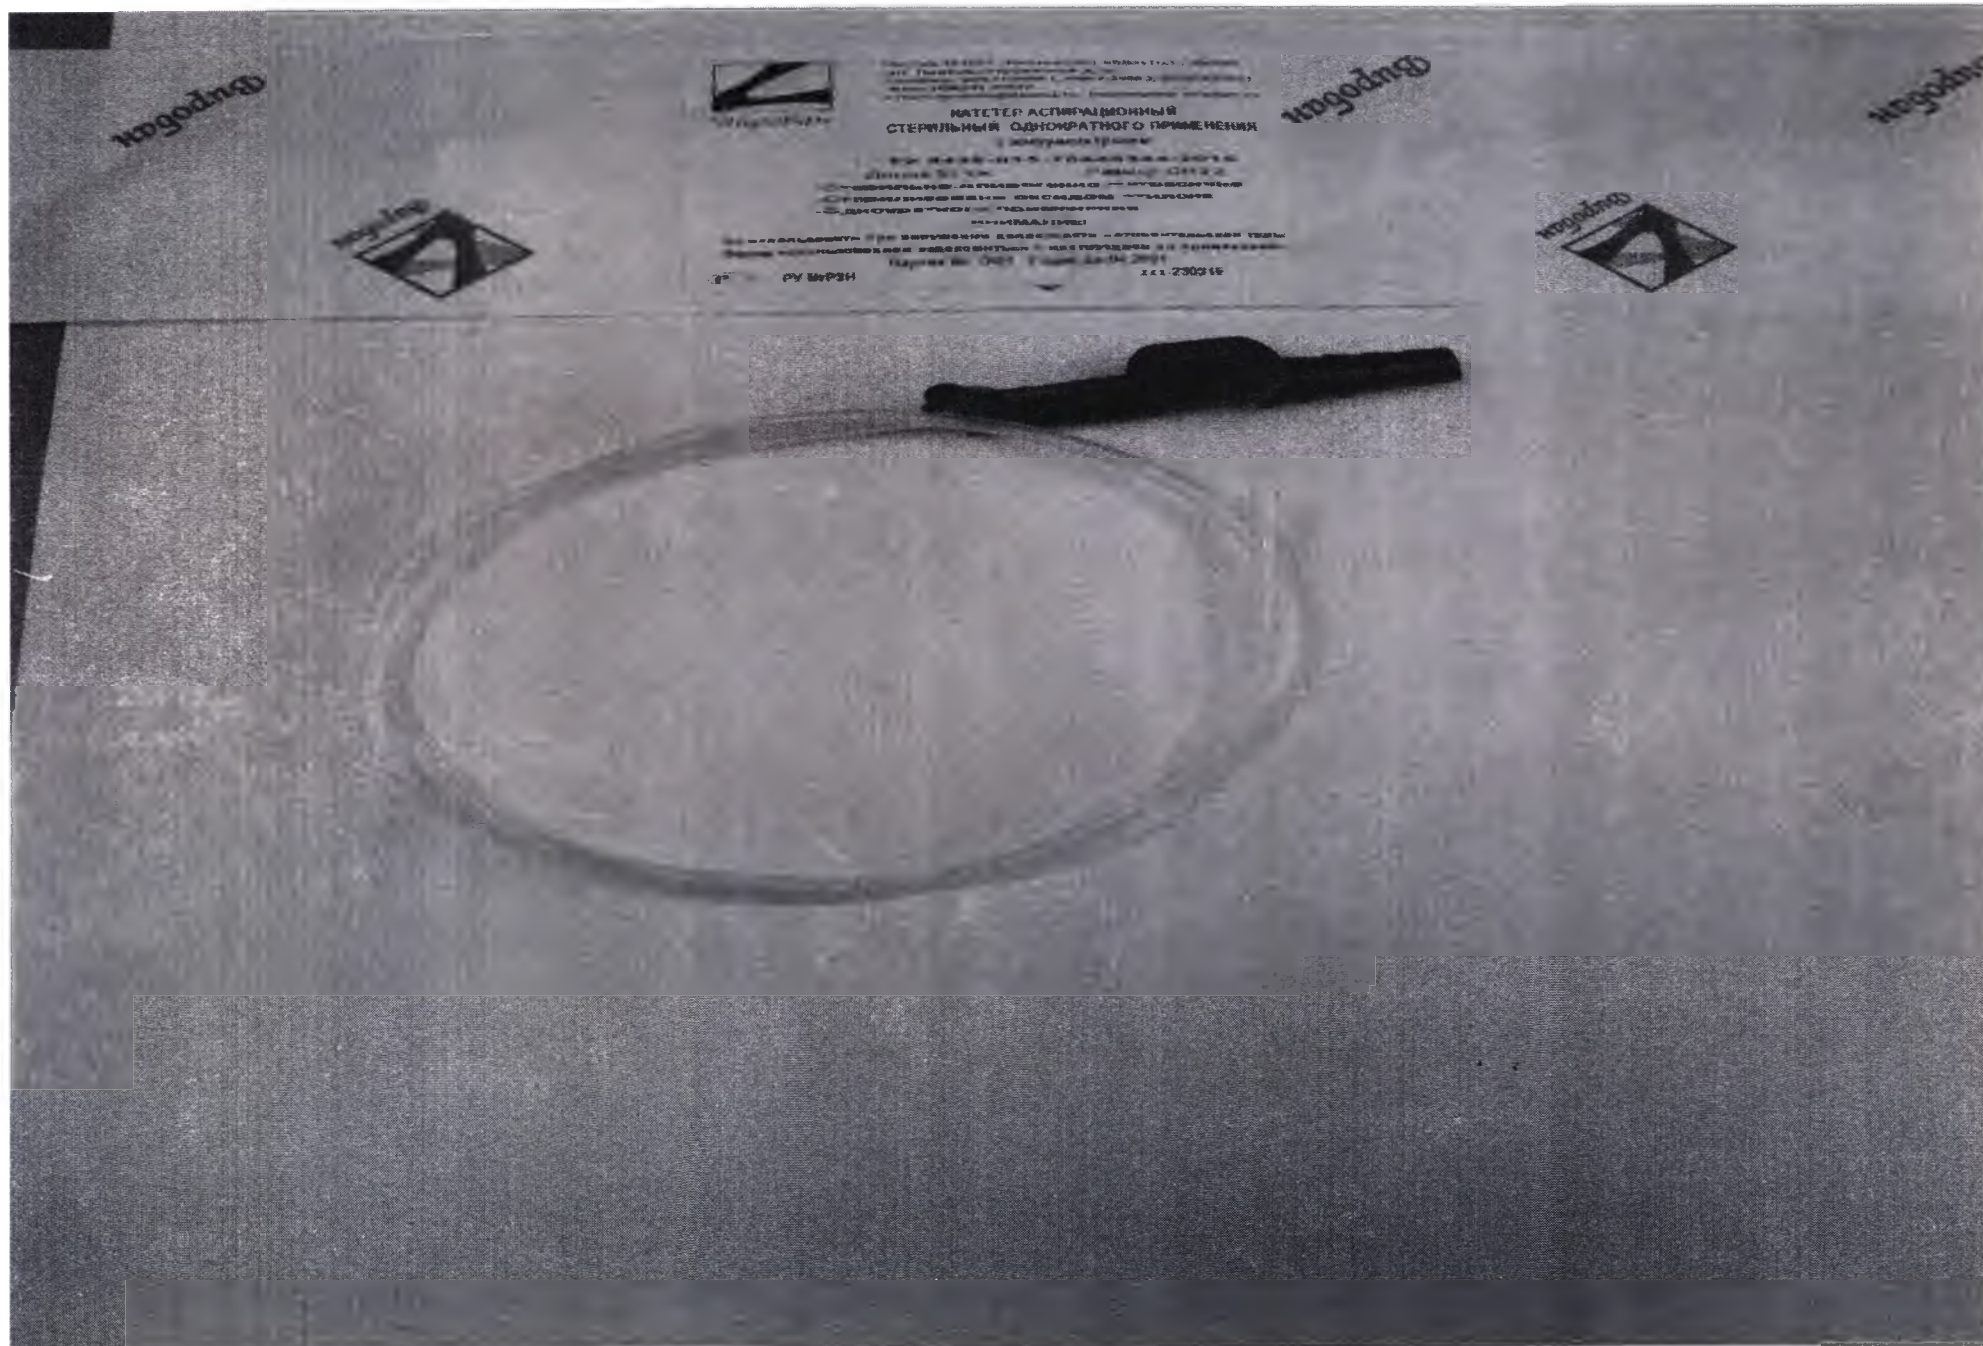

Маркировка потребительской тары Катетеры аспирационные стерильные однократного применения с вакуумконтролем CH22, длина 53 см по ТУ 9436-015-70440344-2016



Виробан

Россия 141981, Московская область, г. Дубна
ул. Приборостроителей д.3а,
Тел/факс: (49621) 28861, 28862, 28863, (495) 7457031,
Факс: (49621) 29022
e-mail: opinion@dubna.ru, <http://www.viroban.ru>

**КАТЕТЕР АСПИРАЦИОННЫЙ
СТЕРИЛЬНЫЙ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
с вакуумконтролем**

ТУ 9436-015-70440344-2016

Длина 53 см

Размер CH22

- Стерильно, Апирогенно, Нетоксично
- Стерилизовано оксидом этилена
- Однократного применения

ВНИМАНИЕ!

Не использовать при нарушении целостности потребительской тары.
Перед использованием ознакомиться с инструкцией по применению.

Партия №: О-01 Годен до: 04.2021

РУ №РЗН

xxx-230316




Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью ООО « Виробан»

21.08.17 л.

Генеральный директор ООО « Виробан»
В.В. Николаев



В исполнении с вакуумконтролем СН24 длина 53 см

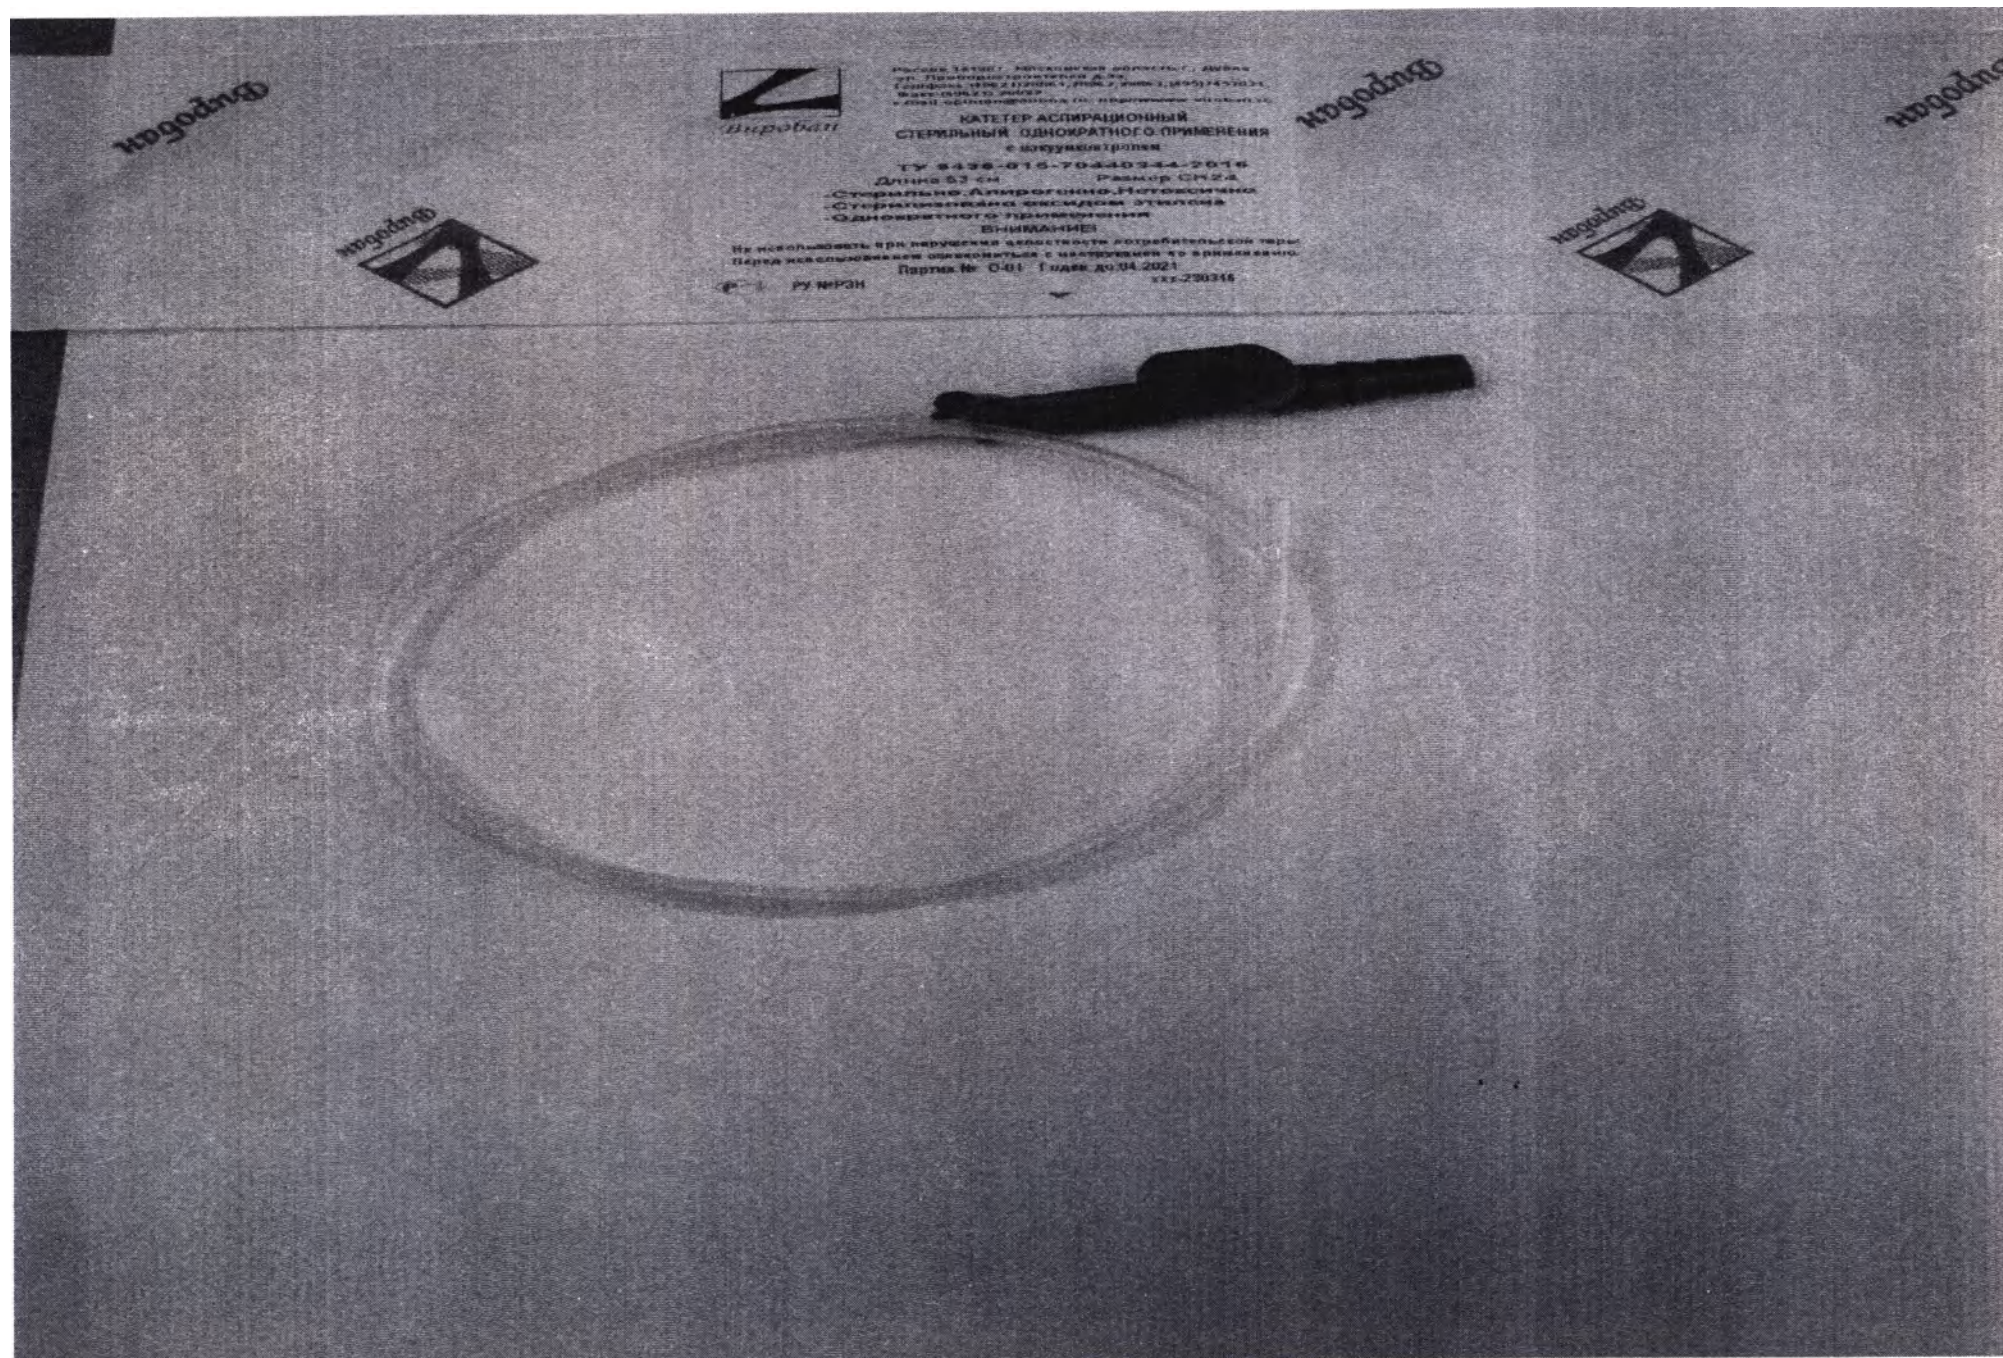

Маркировка потребительской тары Катетеры аспирационные стерильные однократного применения с вакуумконтролем СН24, длина 53 см по ТУ 9436-015-70440344-2016



Виробан

Россия, 141981, Московская область, г. Дубна
ул. Приборостроителей д.3а,
Тел/факс: (49621) 28861, 28862, 28863, (495) 7457031,
Факс: (49621) 29022
e-mail: opinion@dubna.ru, <http://www.viroban.ru>

**КАТЕТЕР АСПИРАЦИОННЫЙ
СТЕРИЛЬНЫЙ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
с вакуумконтролем**

ТУ 9436-015-70440344-2016

Длина 53 см Размер СН24

- Стерильно, Апирогенно, Нетоксично
- Стерилизовано оксидом этилена
- Однократного применения

ВНИМАНИЕ!

Не использовать при нарушении целостности потребительской тары.
Перед использованием ознакомиться с инструкцией по применению.

Партия №: 0-01 Годен до: 04.2021

Р РУ №РЗН

xxx-220316



Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью ООО « Виробан»

21.08.2017 л.

Генеральный директор ООО « Виробан»

В.В. Николаев

Адрес: 141001, Московская область, г. Дзержинск
ул. Ткачиха, д. 10
Телефон: (495) 271-00-01, 271-00-02, 271-00-03
Факс: (495) 271-00-04
e-mail: info@viroban.ru

**КАТЕТЕР АДЪИРАЦИОННЫЙ
СТЕРИЛЬНЫЙ ОДНОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ
с вакуумконтролем**

ТУ 9430-010-70-40344-2016
Длина 60 см Радиус СМ-4
Стерильно, Адъирировано, Неподвижно
Стерилизовано, Стерилизовано, Стерилизовано
Однократного применения

ВНИМАНИЕ!
Не использовать при нарушении целостности потребительской тары.
Перед использованием ознакомиться с инструкцией по применению.
Партия № 0-01. Годен до 04.2021

РУ НРДН 211-230316

Маркировка потребительской тары Катетеры аспирационные стерильные однократного применения с вакуумконтролем СН4, длина 60 см по ТУ 9436-015-70440344-2016



Viroban

Россия, 141981, Московская область, г. Дубна
ул. Приборостроителей д. 3а,
Тел/факс: (49621) 23861, 23862, 23863, (495) 7457031.
Факс (49621) 29022
e-mail: opinion@dubna.ru, <http://www.viroban.ru>

**КАТЕТЕР АСПИРАЦИОННЫЙ
СТЕРИЛЬНЫЙ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
с вакуумконтролем**

ТУ 9436-015-70440344-2016

Длина 60 см

Размер СН4

- Стерильно, Апирогенно, Нетоксично
- Стерилизовано оксидом этилена
- Однократного применения

ВНИМАНИЕ!

Не использовать при нарушении целостности потребительской тары.
Перед использованием ознакомиться с инструкцией по применению.

Партия №: О-01 Годен до: 04.2021

Р РУ №РЗН

xxx-230316




Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью ООО « Виробан»

21.08.2017 л.


Генеральный директор ООО « Виробан»

В.В. Николаев

В исполнении с вакуумконтролем СН5 длина 60 см

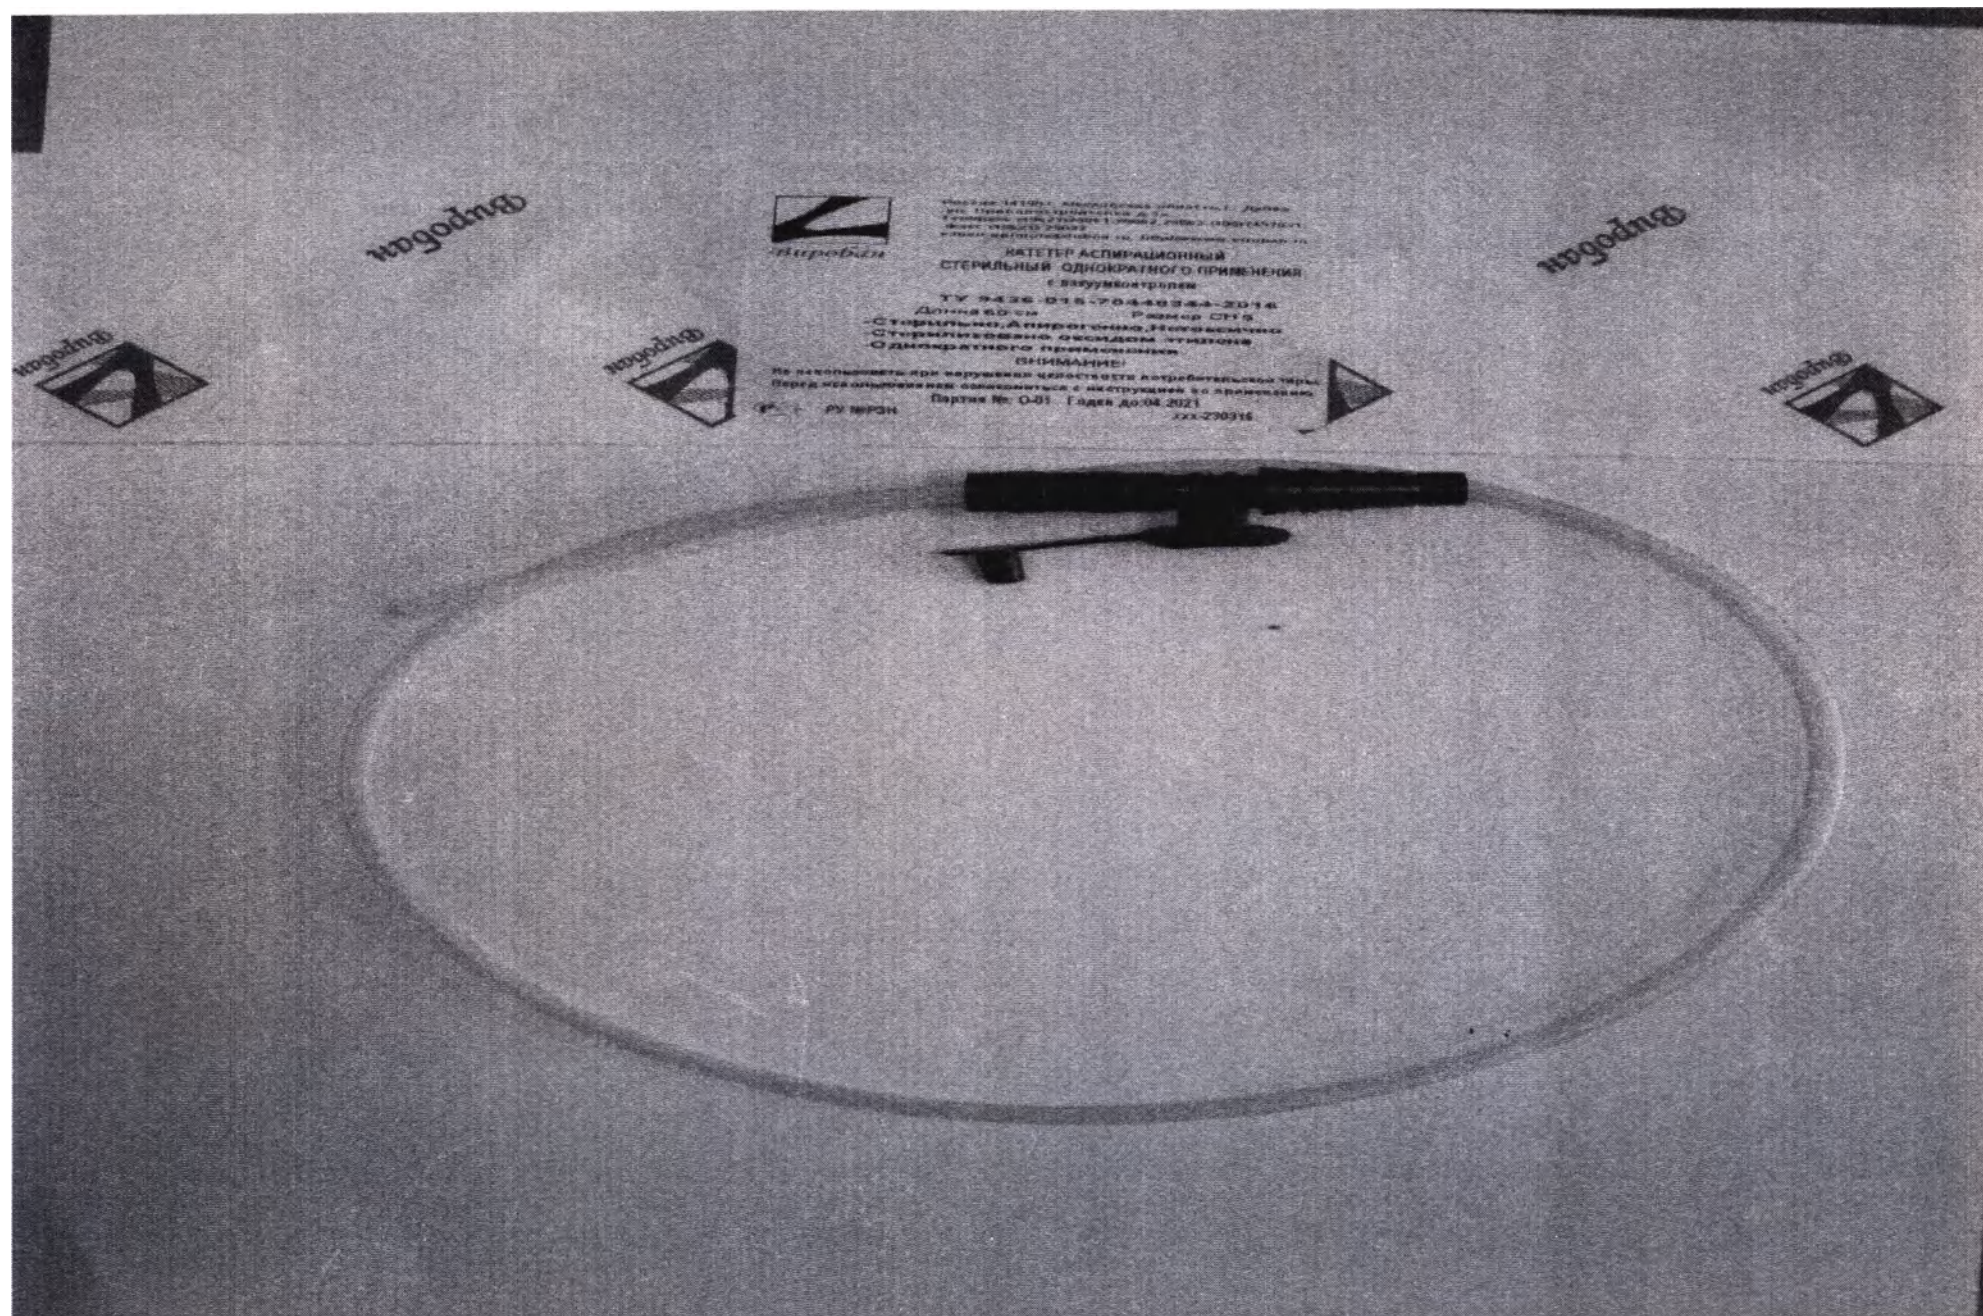

Маркировка потребительской тары Катетеры аспирационные стерильные однократного применения с вакуумконтролем CH5, длина 60 см по ТУ 9436-015-70440344-2016



Виробан

Россия, 141981, Московская область, г. Дубна
ул. Приборостроителей д. 3а,
Тел/факс: (49621) 23861, 23862, 23863, (495) 7457031.
Факс: (49621) 29022
e-mail: opinion@dubna.ru, <http://www.viroban.ru>

**КАТЕТЕР АСПИРАЦИОННЫЙ
СТЕРИЛЬНЫЙ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
с вакуумконтролем**

ТУ 9436-015-70440344-2016

Длина 60 см

Размер CH 5

- Стерильно, Апиrogenно, Нетоксично
- Стерилизовано оксидом этилена
- Однократного применения

ВНИМАНИЕ!

Не использовать при нарушении целостности потребительской тары.
Перед использованием ознакомиться с инструкцией по применению.

Партия №: 0-01 Годен до: 04.2021

РГ РУ №РЗН

xxx-220316



Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью ООО « Виробан»

21.04.17 л.

Генеральный директор ООО « Виробан»

В.В. Николаев


 Россия, 191591, Московская область, г. Дубна
 ул. Приборостроителей д. 3а
 Тел/факс: (49621) 28381, 28382, (495) 7457091; Факс: (49621) 28722
 e-mail: oripromo@dubna.ru, <http://www.virobalt.ru>

КАТЕТЕР АСПИРАЦИОННЫЙ
СТЕРИЛЬНЫЙ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
 с вакуумконтролем


ТУ 9436-015-70440344-2016
 Длина 60 см Размер СН 6

Стерильность, Антибактериальность, Катетеризация
 Стерильность, Антибактериальность, Катетеризация
 Стерильность, Антибактериальность, Катетеризация

ВНИМАНИЕ!
 не использовать при нарушении целостности потребительской тары
 Перед использованием ознакомиться с инструкцией по применению

Годен до: 04.2021 Партия №: О-01

РУМРЭН ХХ-230316

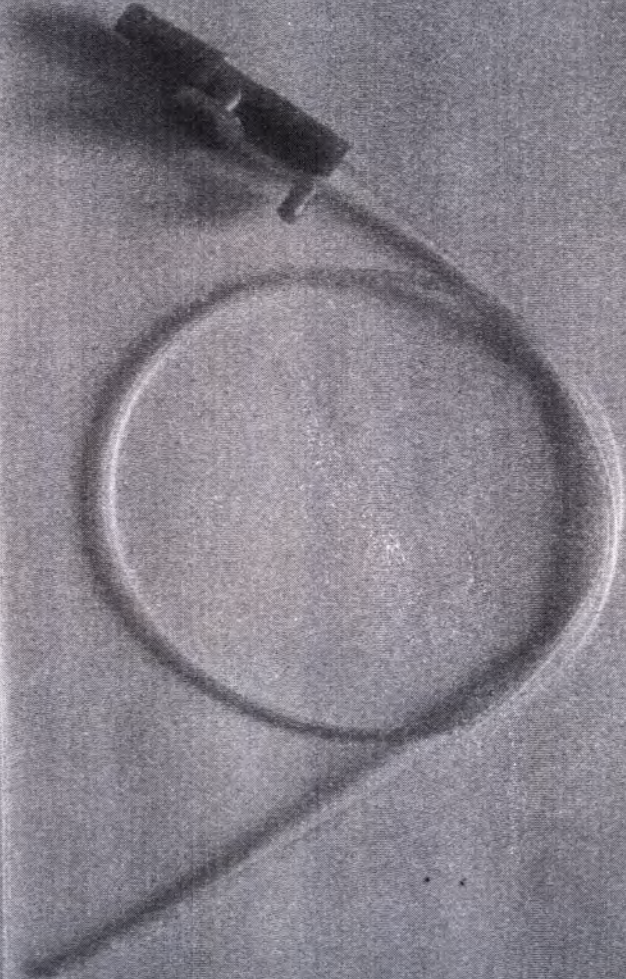

Маркировка потребительской тары Катетеры аспирационные стерильные однократного применения с вакуумконтролем СН6, длина 60 см по ТУ 9436-015-70440344-2016



Виробан

Россия, 141981, Московская область, г. Дубна
ул. Приборостроителей д. 3а,
Тел/факс: (49621) 23861, 23862, 23863, (495) 7457031,
Факс: (49621) 29022
e-mail: opinion@dubna.ru, <http://www.viroban.ru>

**КАТЕТЕР АСПИРАЦИОННЫЙ
СТЕРИЛЬНЫЙ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
с вакуумконтролем**

ТУ 9436-015-70440344-2016

Длина 60 см

Размер СН 6

-Стерильно, Апиrogenно, Нетоксично

-Стерилизовано оксидом этилена

-Однократного применения

ВНИМАНИЕ!

**Не использовать при нарушении целостности потребительской тары.
Перед использованием ознакомиться с инструкцией по применению.**

Партия №: О-01 Годен до: 04.2021

Р

РУ №РЗН

xxx-230316



Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью ООО « Виробан»

21.08.2017 л.

Генеральный директор ООО « Виробан»

В.В. Николаев



Маркировка потребительской тары Катетеры аспирационные стерильные однократного применения с вакуумконтролем СН8, длина 60 см по ТУ 9436-015-70440344-2016



Виробан

Россия, 141981, Московская область, Дубна
ул. Приборостроителей д.3а
Тел/факс (4962) 238661, 238662, 238663, (495) 7457031
Факс (49621) 23022
e-mail: oripnion@dubna.ru, <http://www.viroban.ru>

**КАТЕТЕР АСПИРАЦИОННЫЙ
СТЕРИЛЬНЫЙ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
с вакуумконтролем**

ТУ 9436-015-70440344-2016

Длина 60 см

Размер СН8

- Стерильно, Апирогенно, Нетоксично**
- Стерилизовано оксидом этилена**
- Однократного применения**


ВНИМАНИЕ!

**Не использовать при нарушении целостности потребительской тары.
Перед использованием ознакомиться с инструкцией по применению.**

Партия №: О-01 Годен до: 04.2021

Р **РУ №РЗН**

xxx-230316






Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью ООО « Виробан»

21.08.2017 л.

Генеральный директор ООО « Виробан»

В.В. Николаев

Маркировка потребительской тары Катетеры аспирационные стерильные однократного применения с вакуумконтролем СН10, длина 60 см по ТУ 9436-015-70440344-2016



Виробан

Россия, 141981, Московская область, г. Дубна
ул. Приборостроителей д. 3а,
Тел/Факс: (49621) 23861, 23862, 23863, (495) 7457031,
Факс: (49621) 29022
e-mail: opinion@dubna.ru, <http://www.viroban.ru>

**КАТЕТЕР АСПИРАЦИОННЫЙ
СТЕРИЛЬНЫЙ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
с вакуумконтролем**

ТУ 9436-015-70440344-2016

Длина 60 см Размер СН10

- Стерильно, Апирогенно, Нетоксично
- Стерилизовано оксидом этилена
- Однократного применения

ВНИМАНИЕ!

Не использовать при нарушении целостности потребительской тары.
Перед использованием ознакомиться с инструкцией по применению.

Партия №: 0-01 Годен до: 04.2021



РУ №РЗН

xxx-230316




Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью ООО « Виробан»

21.08.2017 л.


Генеральный директор ООО « Виробан»

В.В. Николаев

В исполнении с вакуумконтролем СН12 длина 60 см

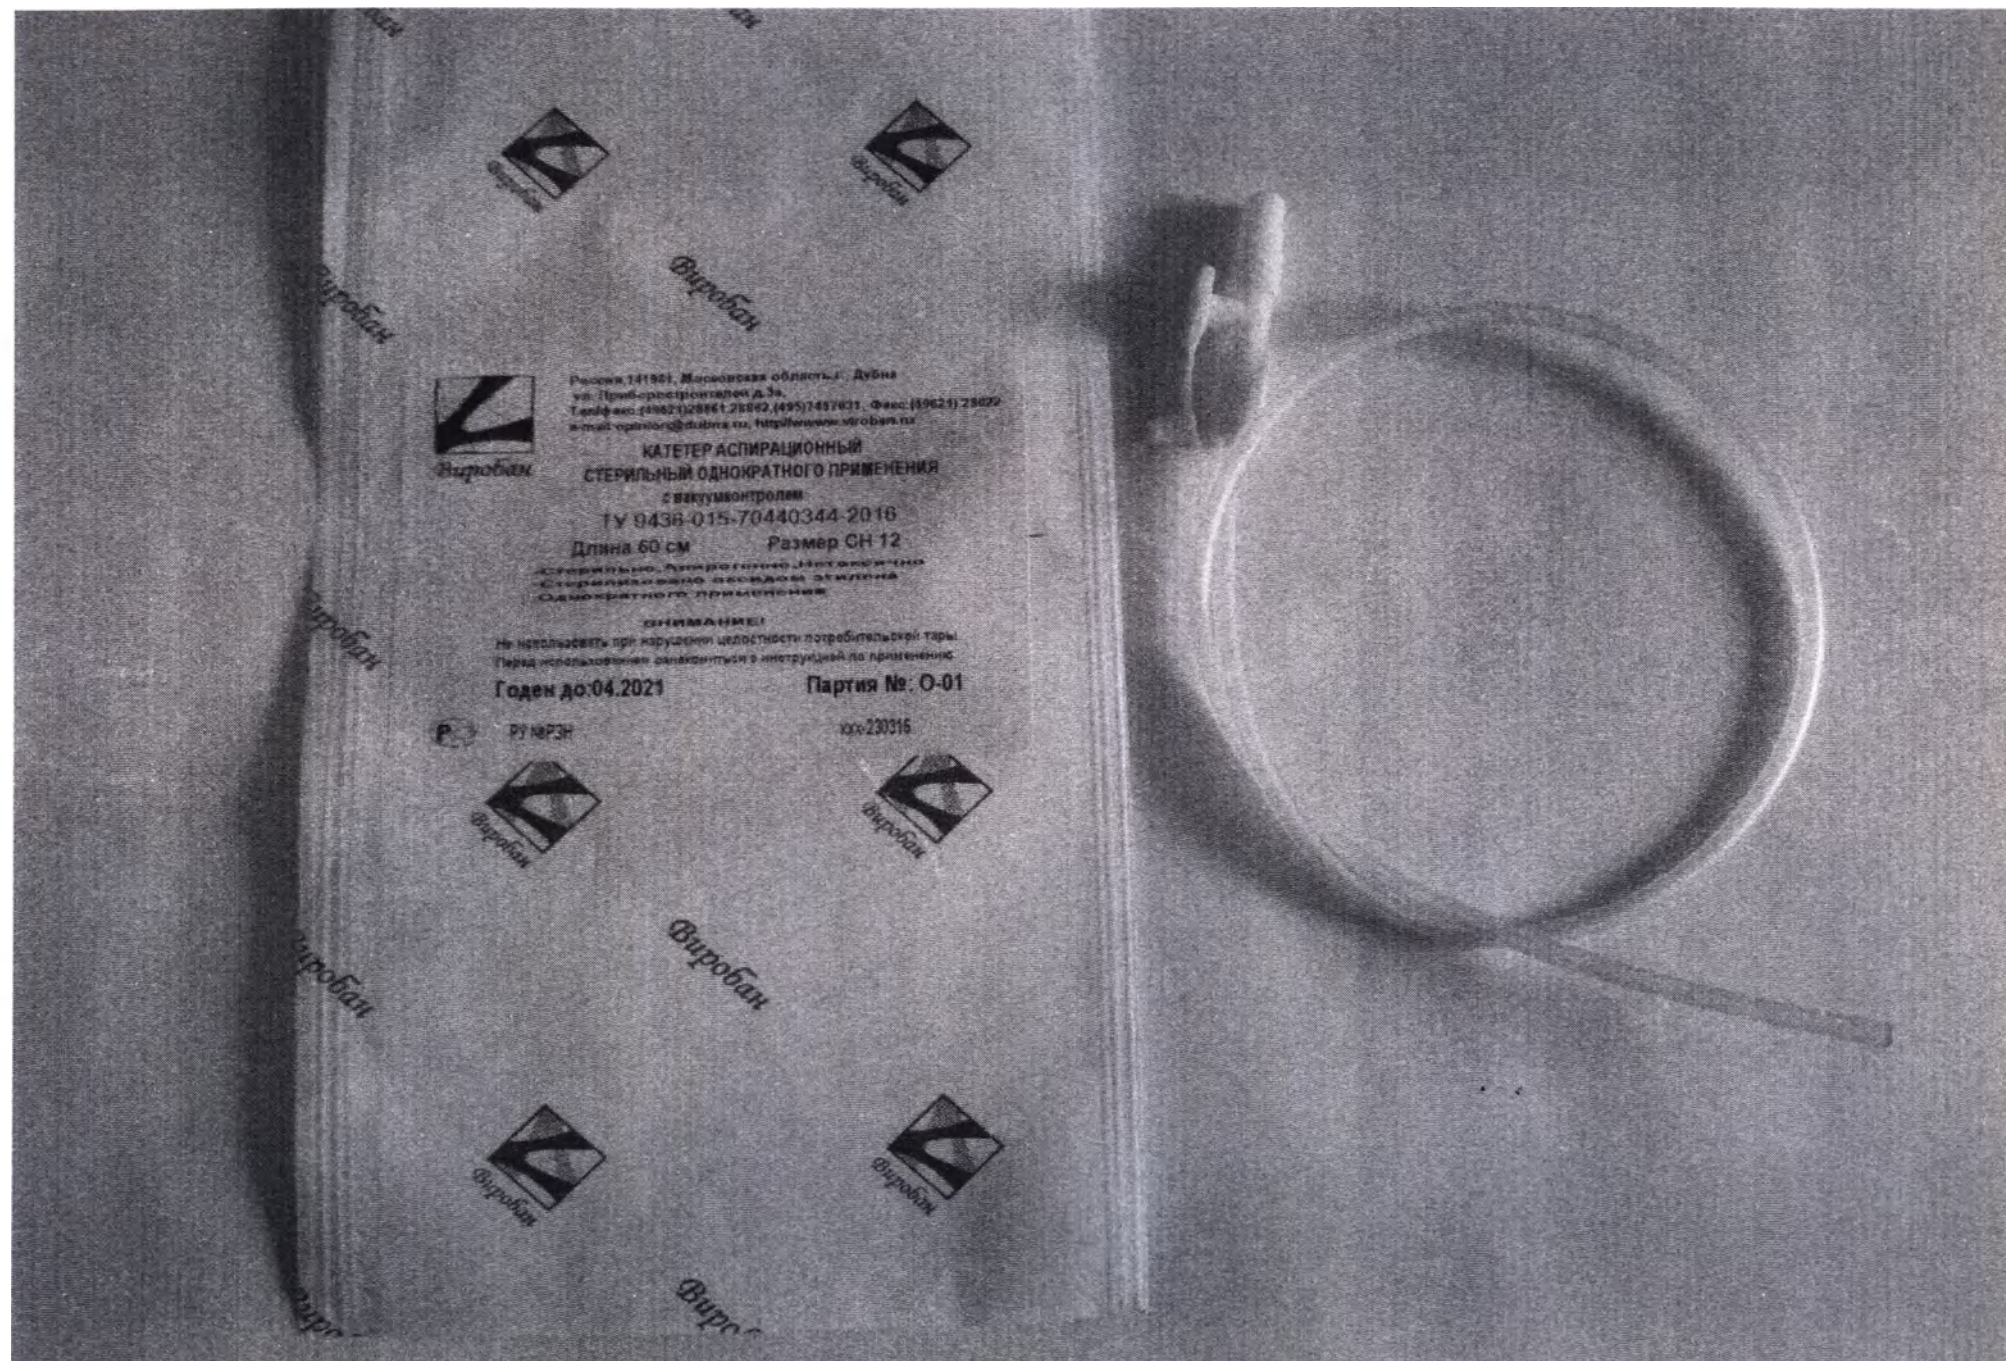

Маркировка потребительской тары Катетеры аспирационные стерильные однократного применения с вакуумконтролем СН12, длина 60 см по ТУ 9436-015-70440344-2016



Виробан

Россия 141981, Московская область, г. Дубна
ул. Приборостроителей д.3а,
Тел/факс (49621) 28861, 28362, 28863, (495) 7457031,
Факс: (49621) 29022
e-mail: opinion@dubna.ru, <http://www.viroban.ru>

**КАТЕТЕР АСПИРАЦИОННЫЙ
СТЕРИЛЬНЫЙ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
с вакуумконтролем**

ТУ 9436-015-70440344-2016

Длина 60 см

Размер СН 12

**- Стерильно, Апирогенно, Нетоксично
- Стерилизовано оксидом этилена
- Однократного применения**

ВНИМАНИЕ!

**Не использовать при нарушении целостности потребительской тары.
Перед использованием ознакомиться с инструкцией по применению.**

Партия №: О-01 Годен до: 04.2021

РГ РУ №РЗН

xxx-230316




Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью ООО « Виробан»

21.07.2017 л.

Генеральный директор ООО « Виробан»

В.В. Николаев

В исполнении с вакуумконтролем СН14 длина 60 см

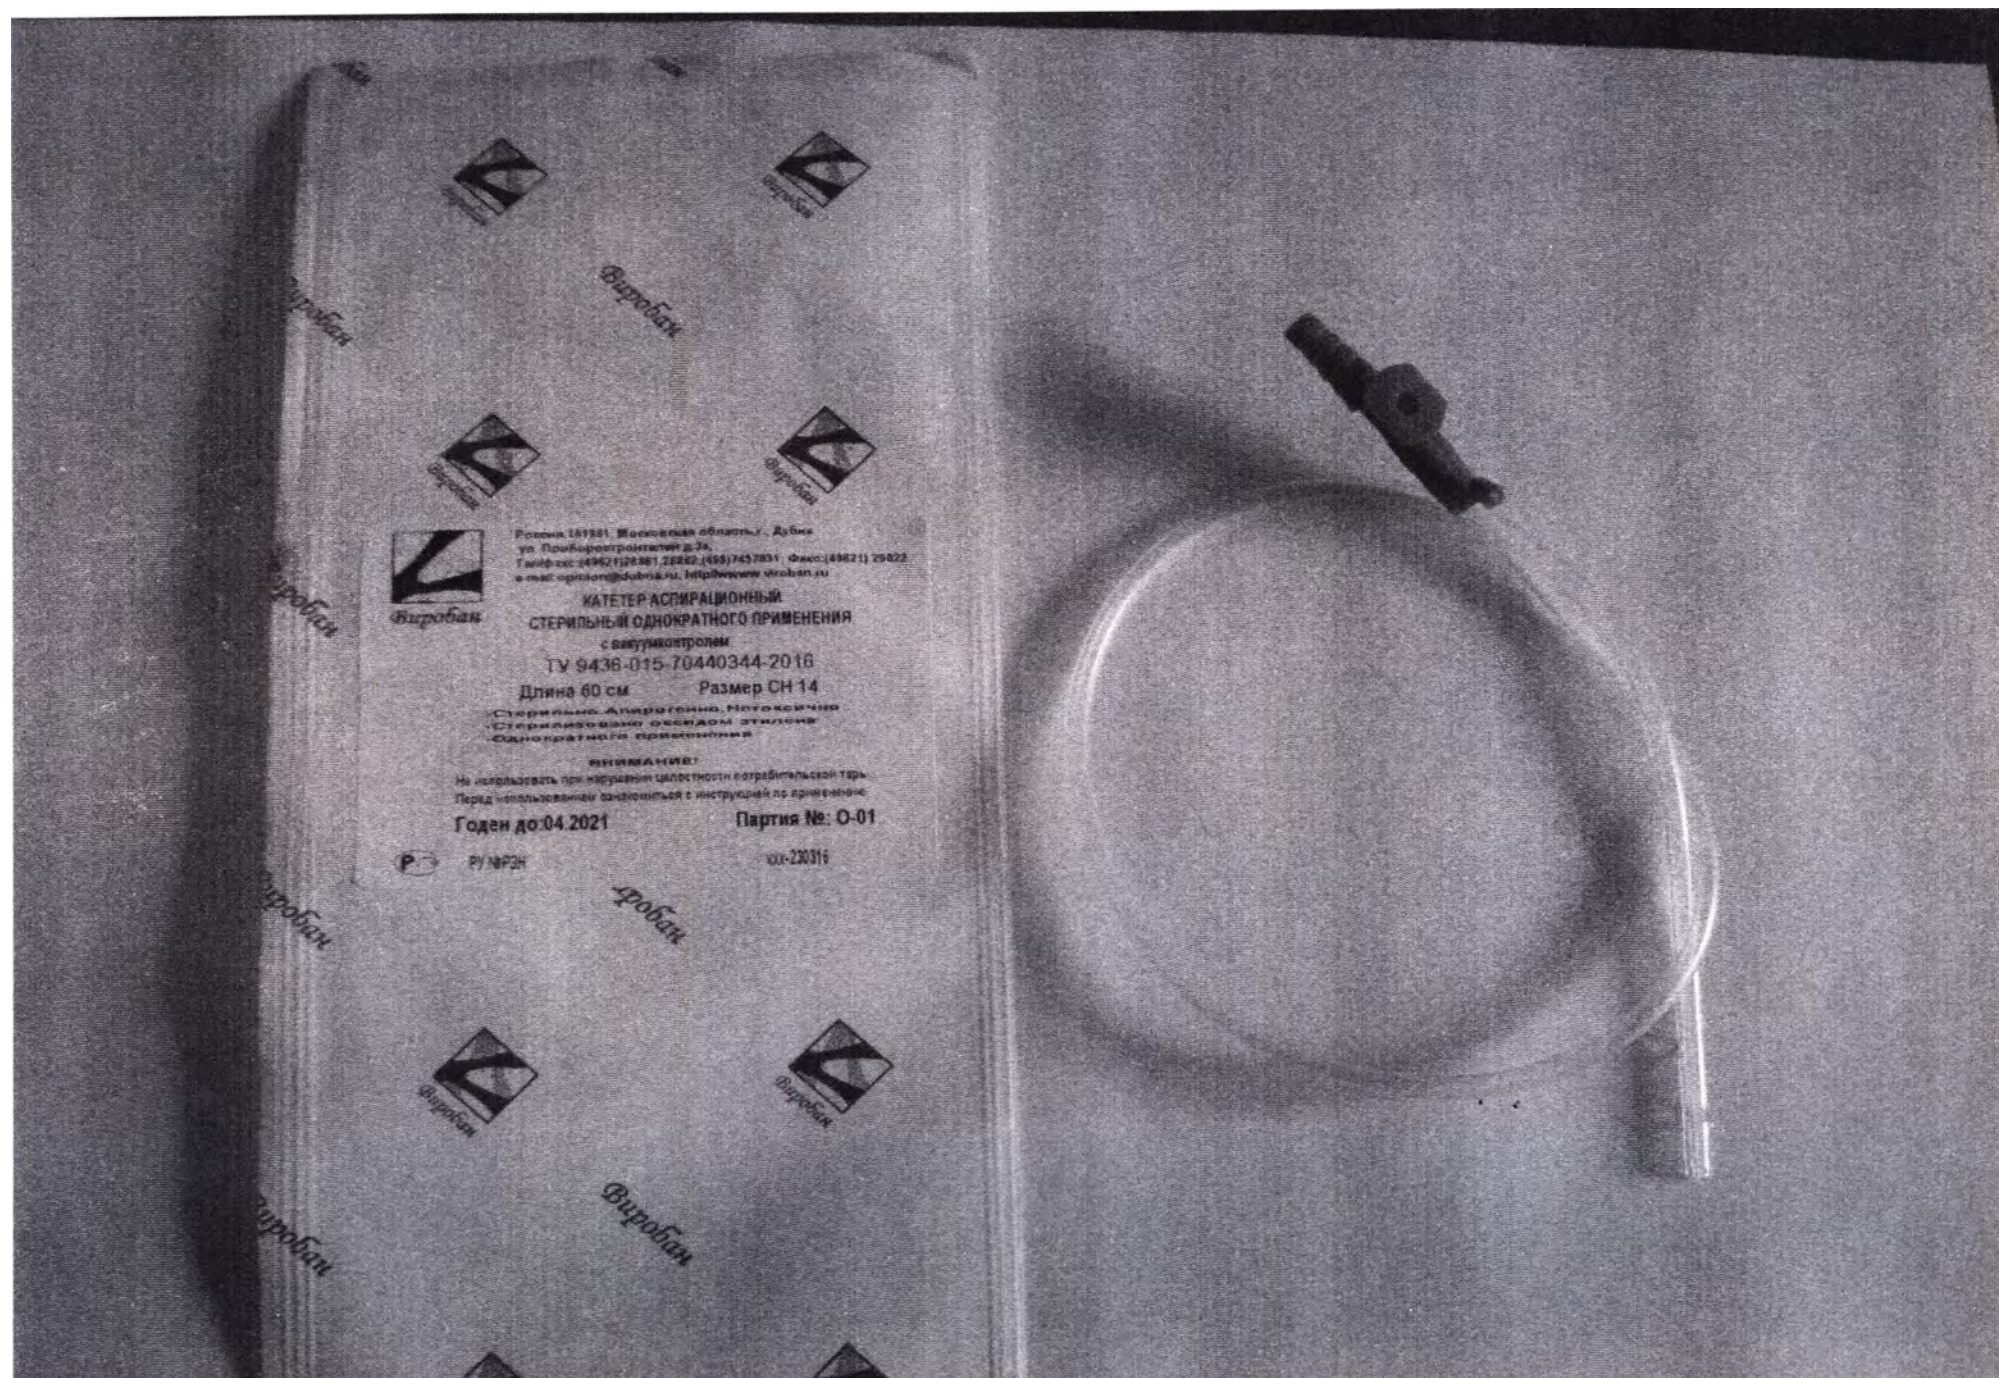

Маркировка потребительской тары Катетеры аспирационные стерильные однократного применения с вакуумконтролем СН14, длина 60 см по ТУ 9436-015-70440344-2016



Виробан

Россия 141981, Московская область, г. Дубна
ул. Приборостроителей д.3а,
Тел/факс: (49621) 28861, 28862, 28863, (495) 7457031.
Факс: (49621) 29022
e-mail: opinion@dubna.ru, <http://www.viroban.ru>

**КАТЕТЕР АСПИРАЦИОННЫЙ
СТЕРИЛЬНЫЙ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
с вакуумконтролем**

ТУ 9436-015-70440344-2016

Длина 60 см

Размер СН14

- Стерильно, Апирогенно, Нетоксично
- Стерилизовано оксидом этилена
- Однократного применения

ВНИМАНИЕ!

Не использовать при нарушении целостности потребительской тары.
Перед использованием ознакомиться с инструкцией по применению.

Партия №: 0-01 Годен до: 04.2021

Р РУ №РЗН

xxx-230316



Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью ООО « Виробан»

21.08.2017 л.

Генеральный директор ООО « Виробан»

В.В. Николаев

Рязань, 441001, Ярославская область, г. Дубна
ул. Ленин-Дзержинский д. 34
Телефон: (49021) 23081, 23082, (49021) 7051. Факс: (49021) 29002
e-mail: info@viroban.ru, info@viroban.ru

**КАТЕТЕР АСПИРАЦИОННЫЙ
СТЕРИЛЬНЫЙ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
с вакуумконтролем**
ТУ 9436-015-70440344-2016
Длина 60 см Размер СН 16

Стерильно. Асептически. Нетермолабильно.
Стерилизован оксидом этилена.
Однократного применения.

ВНИМАНИЕ!
Не использовать при нарушении целостности аспирационной торы.
Перед использованием ознакомиться с инструкцией по применению.

Годен до: 04.2021 Партия №: 0-01

Р/МРЭН КЗ-20216

Маркировка потребительской тары Катетеры аспирационные стерильные однократного применения с вакуумконтролем СН16, длина 60 см по ТУ 9436-015-70440344-2016



Россия, 141981, Московская область, г., Дубна
ул. Приборостроителей д.3а,
Тел/факс: (49621) 28861, 28862, (495) 7457031; Факс: (49621) 29022
e-mail: opinion@dubna.ru, <http://www.viroban.ru>

**КАТЕТЕР АСПИРАЦИОННЫЙ
СТЕРИЛЬНЫЙ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ**

с вакуумконтролем

ТУ 9436-015-70440344-2016

Длина 60 см

Размер СН 16


- Стерильно, Апирогенно, Нетоксично
- Стерилизовано оксидом этилена
- Однократного применения

ВНИМАНИЕ!

Не использовать при нарушении целостности потребительской тары.
Перед использованием ознакомиться с инструкцией по применению.

Годен до: 04.2021

Партия №: О-01



РУ №РЗН

xxx-230316




Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью ООО « Виробан»

21.08.2017 л.

Генеральный директор ООО « Виробан»

В.В. Николаев

В исполнении с вакуумконтролем СН18 длина 60 см

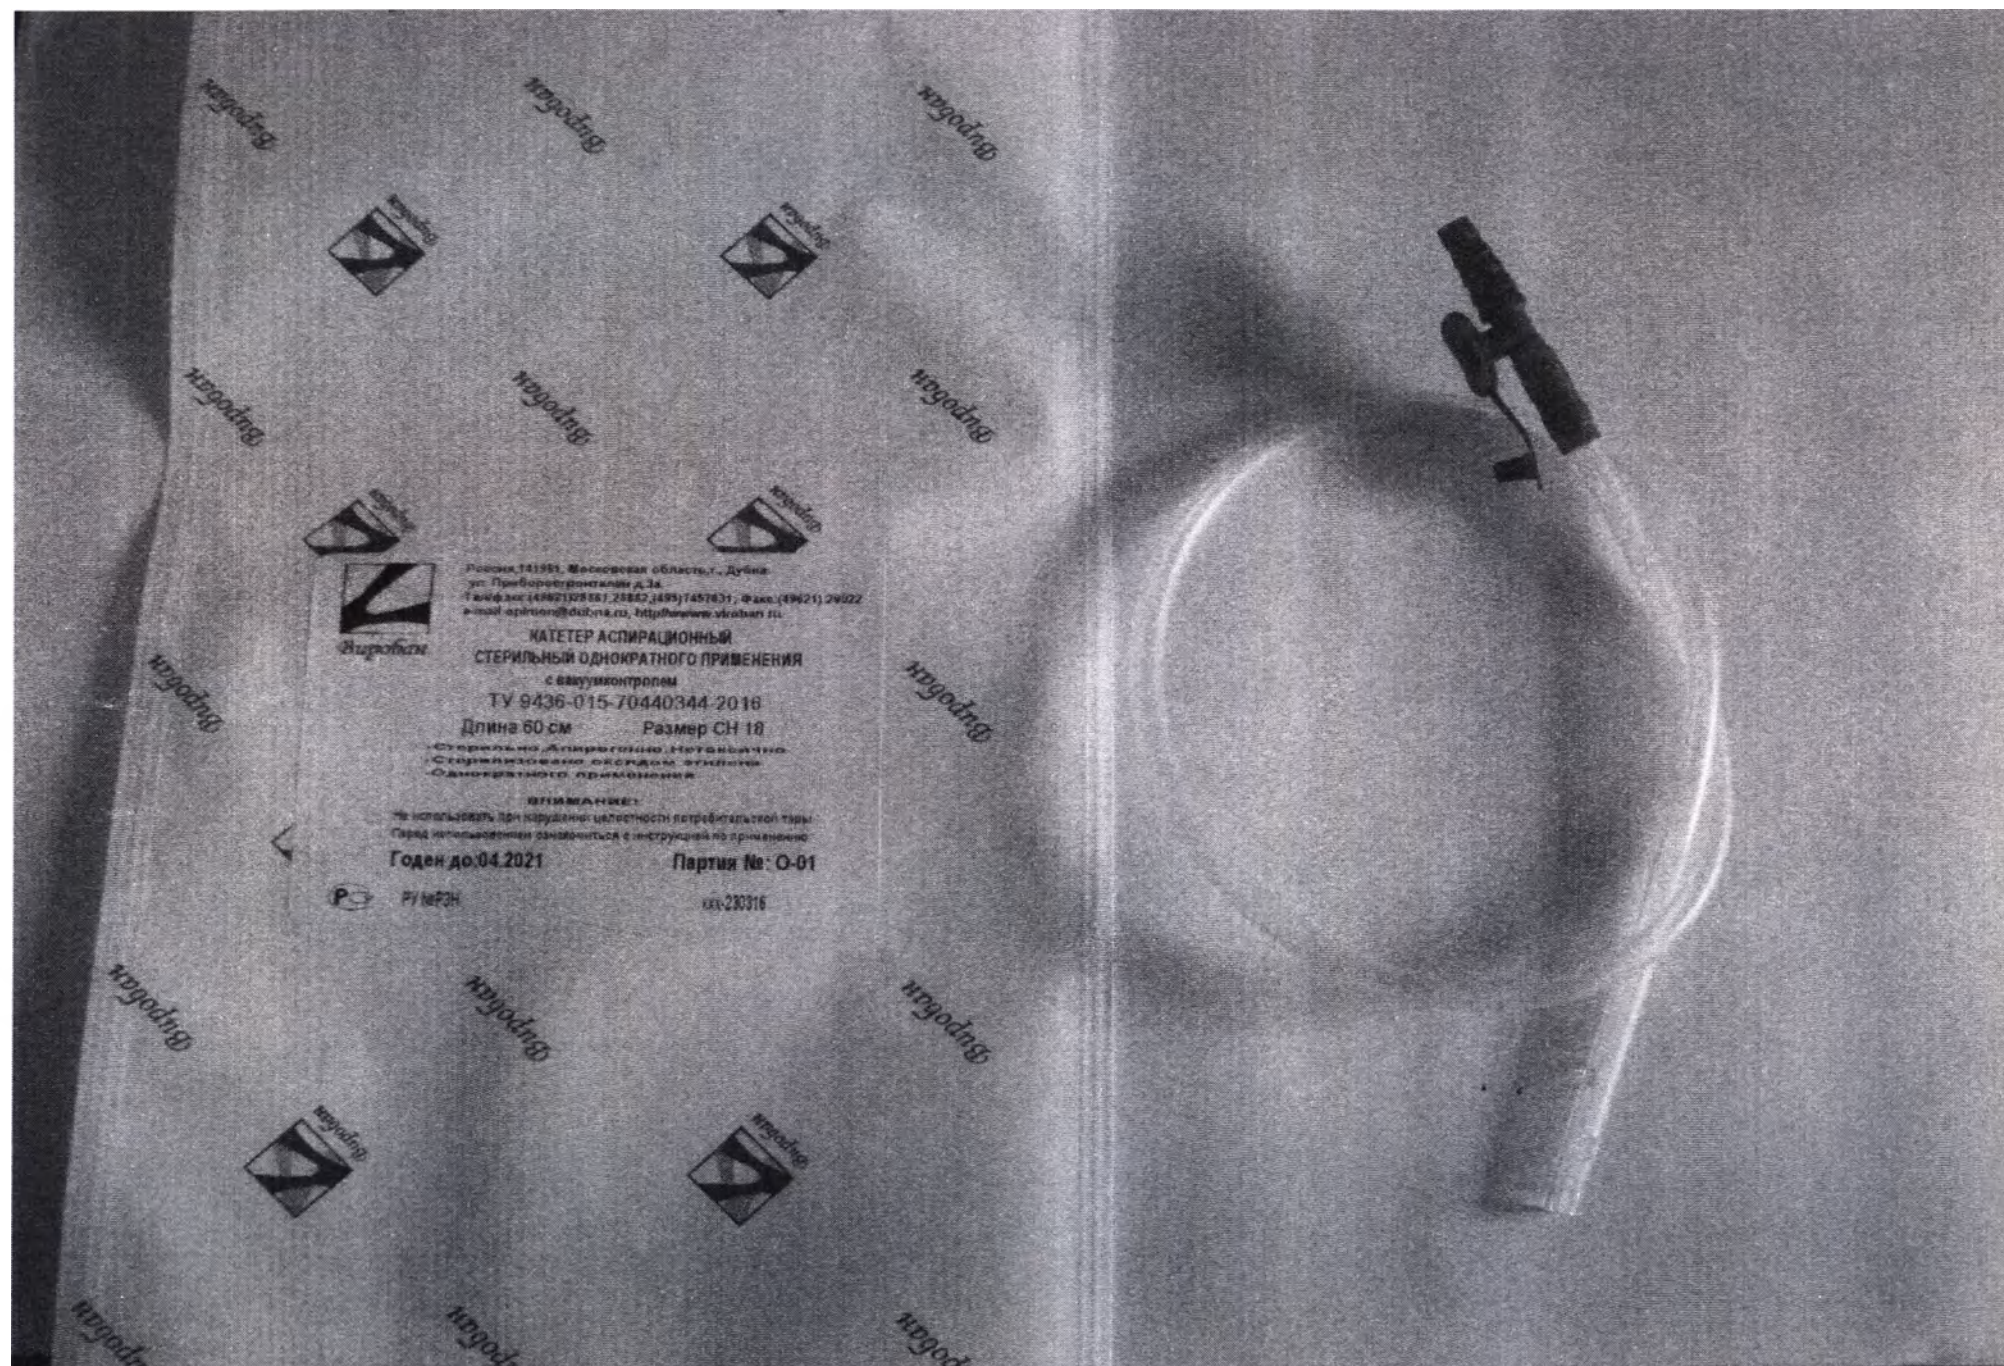

Маркировка потребительской тары Катетеры аспирационные стерильные однократного применения с вакуумконтролем СН18, длина 60 см по ТУ 9436-015-70440344-2016



Viroban

Россия, 141981, Московская область, Дубна
ул. Приборостроителей д. 3а,
Тел/факс (49621) 28661, 28662, 28663, (495) 745 1031
Факс (49621) 29022
e-mail opinion@dubna.ru http://www.viroban.ru

**КАТЕТЕР АСПИРАЦИОННЫЙ
СТЕРИЛЬНЫЙ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
с вакуумконтролем**

ТУ 9436-015-70440344-2016

Длина 60 см

Размер СН 18

- Стерильно, Апирогенно, Нетоксично**
- Стерилизовано оксидом этилена**
- Однократного применения**

ВНИМАНИЕ!

**Не использовать при нарушении целостности потребительской тары.
Перед использованием ознакомиться с инструкцией по применению.**

Партия №: О-01 Годен до: 04.2021

(Р) РУ №РЗН

xxx-230316






Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью ООО « Виробан»

21.08.2017 л.


Генеральный директор ООО « Виробан»

В.В. Николаев

В исполнении с вакуумконтролем СН20 длина 60 см

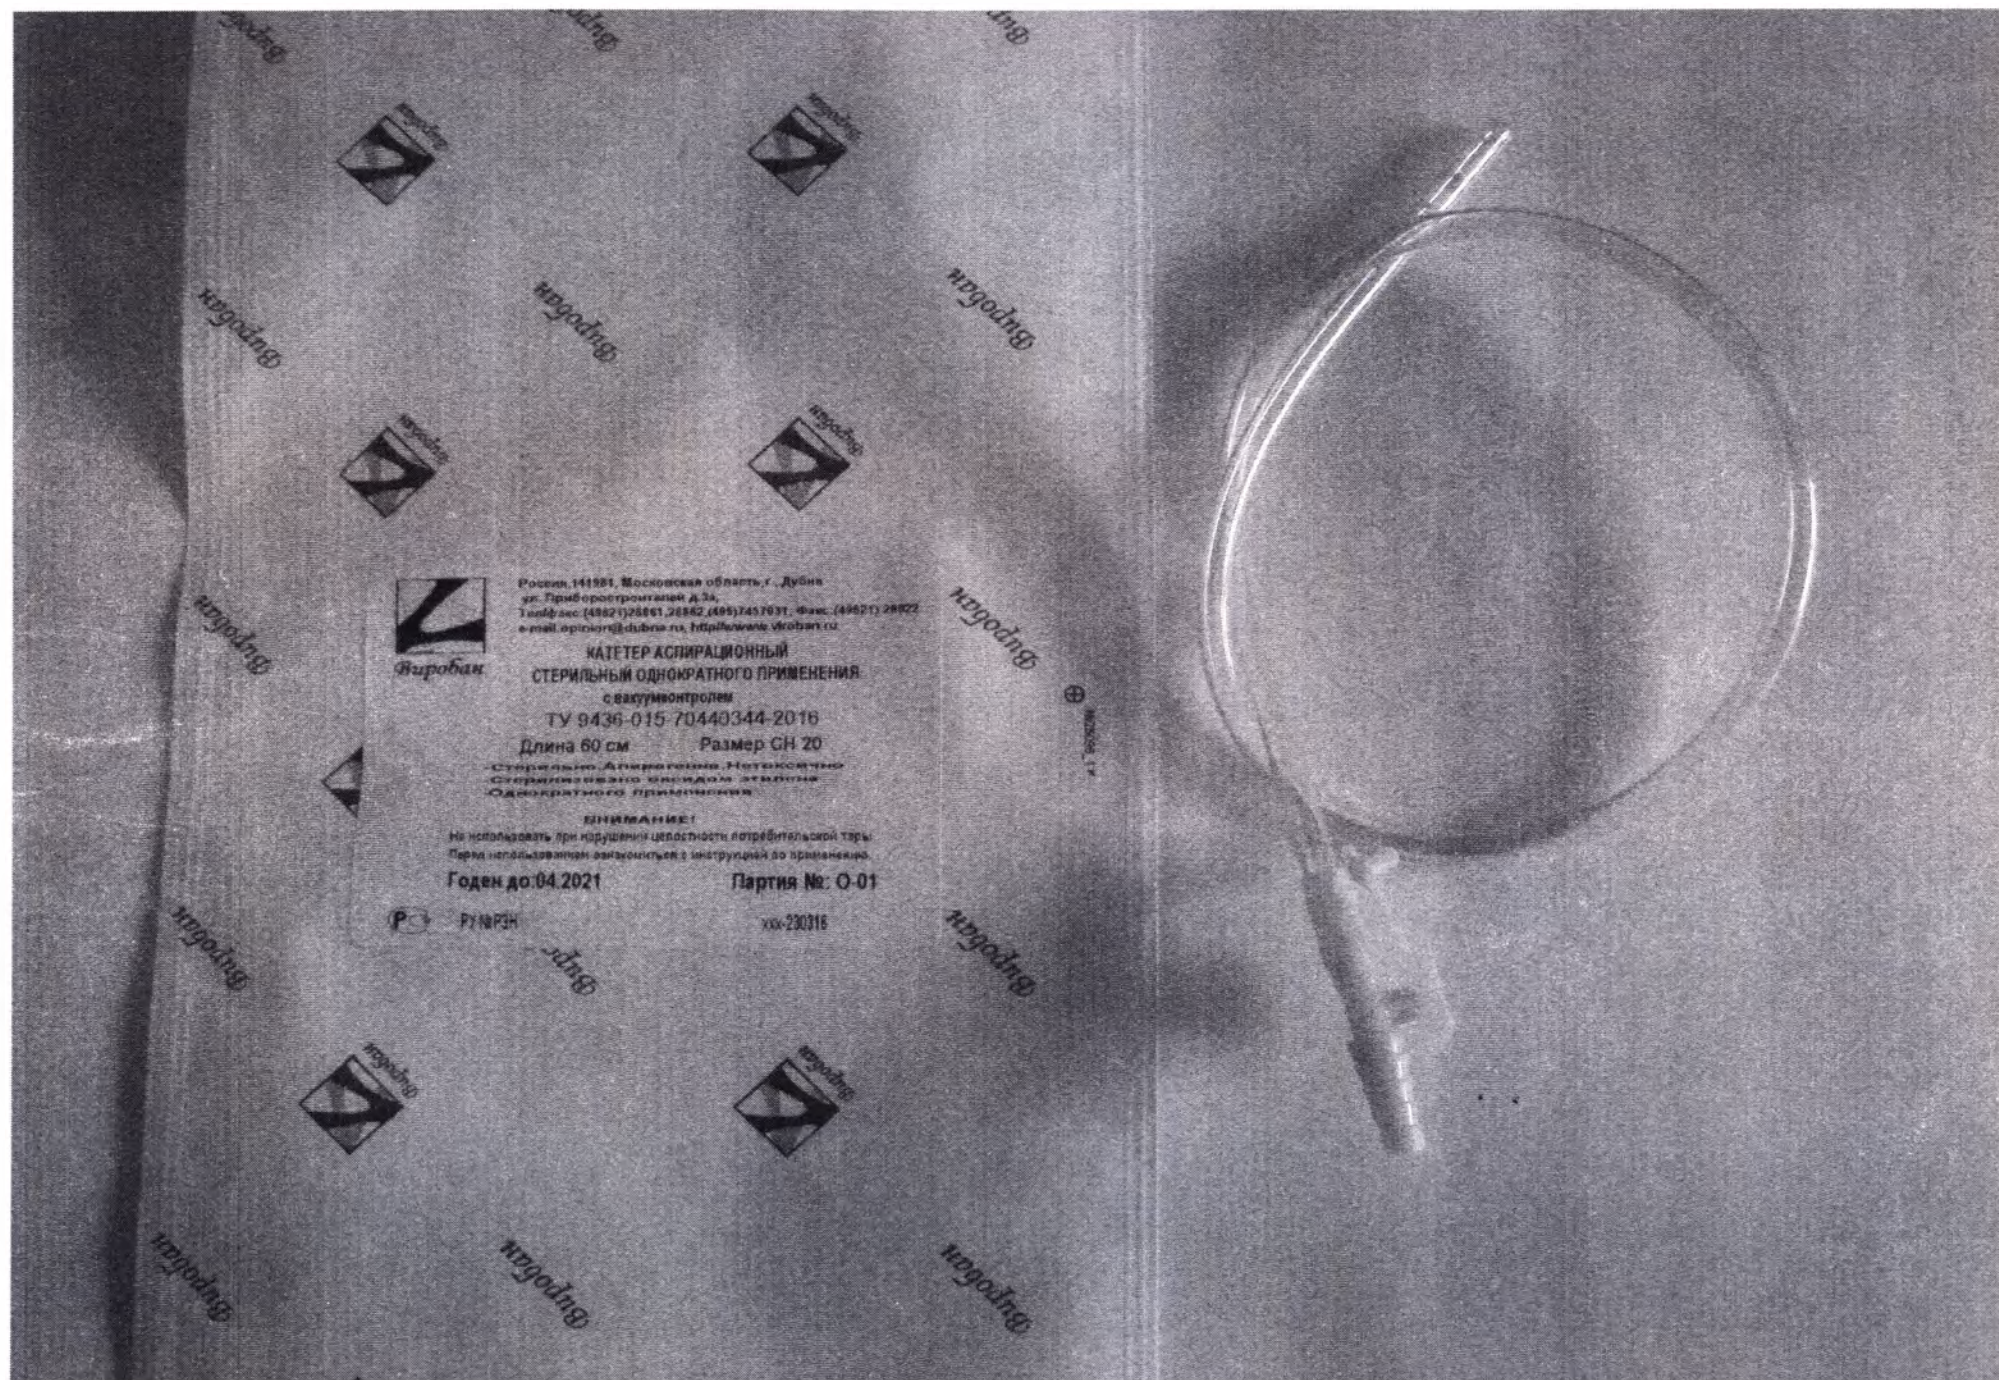

Маркировка потребительской тары Катетеры аспирационные стерильные однократного применения с вакуумконтролем СН20, длина 60 см по ТУ 9436-015-70440344-2016



Виробан

Россия, 141981, Московская область, г. Дубна
ул. Приборостроителей д. 3а,
Тел/факс: (49621) 23861, 23862, 23863, (495) 7457031,
Факс: (49621) 29022
e-mail: opinion@dubna.ru, <http://www.viroban.ru>

**КАТЕТЕР АСПИРАЦИОННЫЙ
СТЕРИЛЬНЫЙ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
с вакуумконтролем**

ТУ 9436-015-70440344-2016

Длина 60 см

Размер СН20

- Стерильно, Апирогенно, Нетоксично
- Стерилизовано оксидом этилена
- Однократного применения

ВНИМАНИЕ!

Не использовать при нарушении целостности потребительской тары.
Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией по применению.

Партия №: 0-01 Годен до: 04.2021



РУ №РЗН

xxx-220316




Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью ООО « Виробан»

21.08.2017 л.

Генеральный директор ООО « Виробан»

В.В. Николаев

В исполнении с вакуумконтролем СН22 длина 60 см

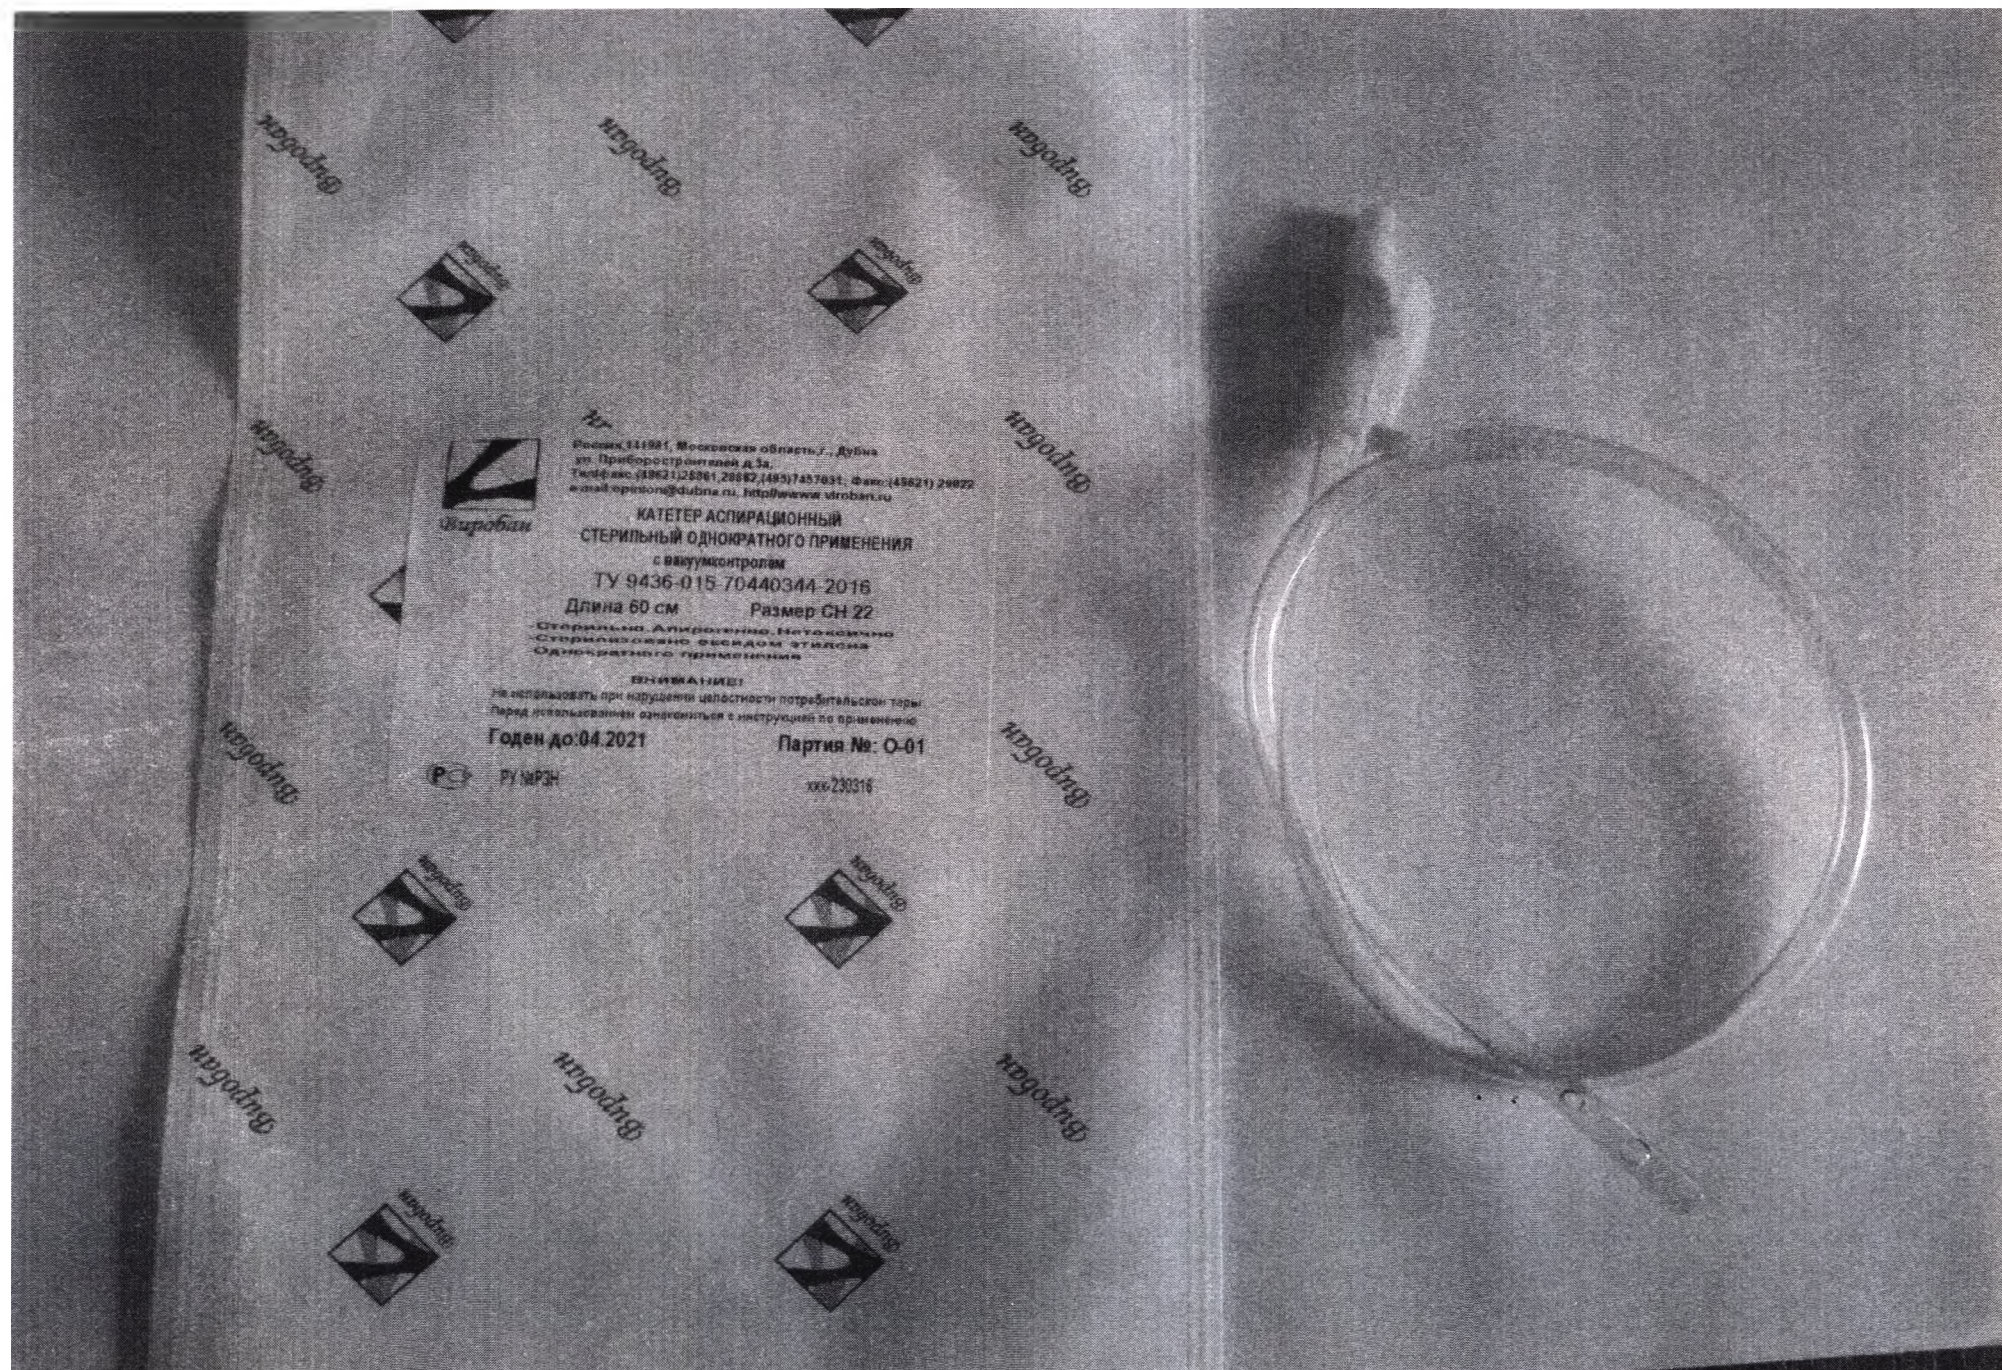

Маркировка потребительской тары Катетеры аспирационные стерильные однократного применения с вакуумконтролем СН22, длина 60 см по ТУ 9436-015-70440344-2016



Виробан

Россия, 141981, Московская область, г. Дубна
ул. Приборостроителей д. 3а,
Тел/факс: (49621) 28861, 28862, 28863, (495) 7457031,
Факс: (49621) 29022
e-mail: opinion@dubna.ru, <http://www.viroban.ru>

**КАТЕТЕР АСПИРАЦИОННЫЙ
СТЕРИЛЬНЫЙ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
с вакуумконтролем**

ТУ 9436-015-70440344-2016

Длина 60 см


Размер СН22

- Стерильно, Апирогенно, Нетоксично
- Стерилизовано оксидом этилена
- Однократного применения

ВНИМАНИЕ!

Не использовать при нарушении целостности потребительской тары.
Перед использованием ознакомиться с инструкцией по применению.

Партия №: О-01 Годен до: 04.2021



РУ №РЗН

xxx-230316




Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью ООО « Виробан»

_____ л.


Генеральный директор ООО « Виробан»

_____ В.В. Николаев

В исполнении с вакуумконтролем СН24 длина 60 см

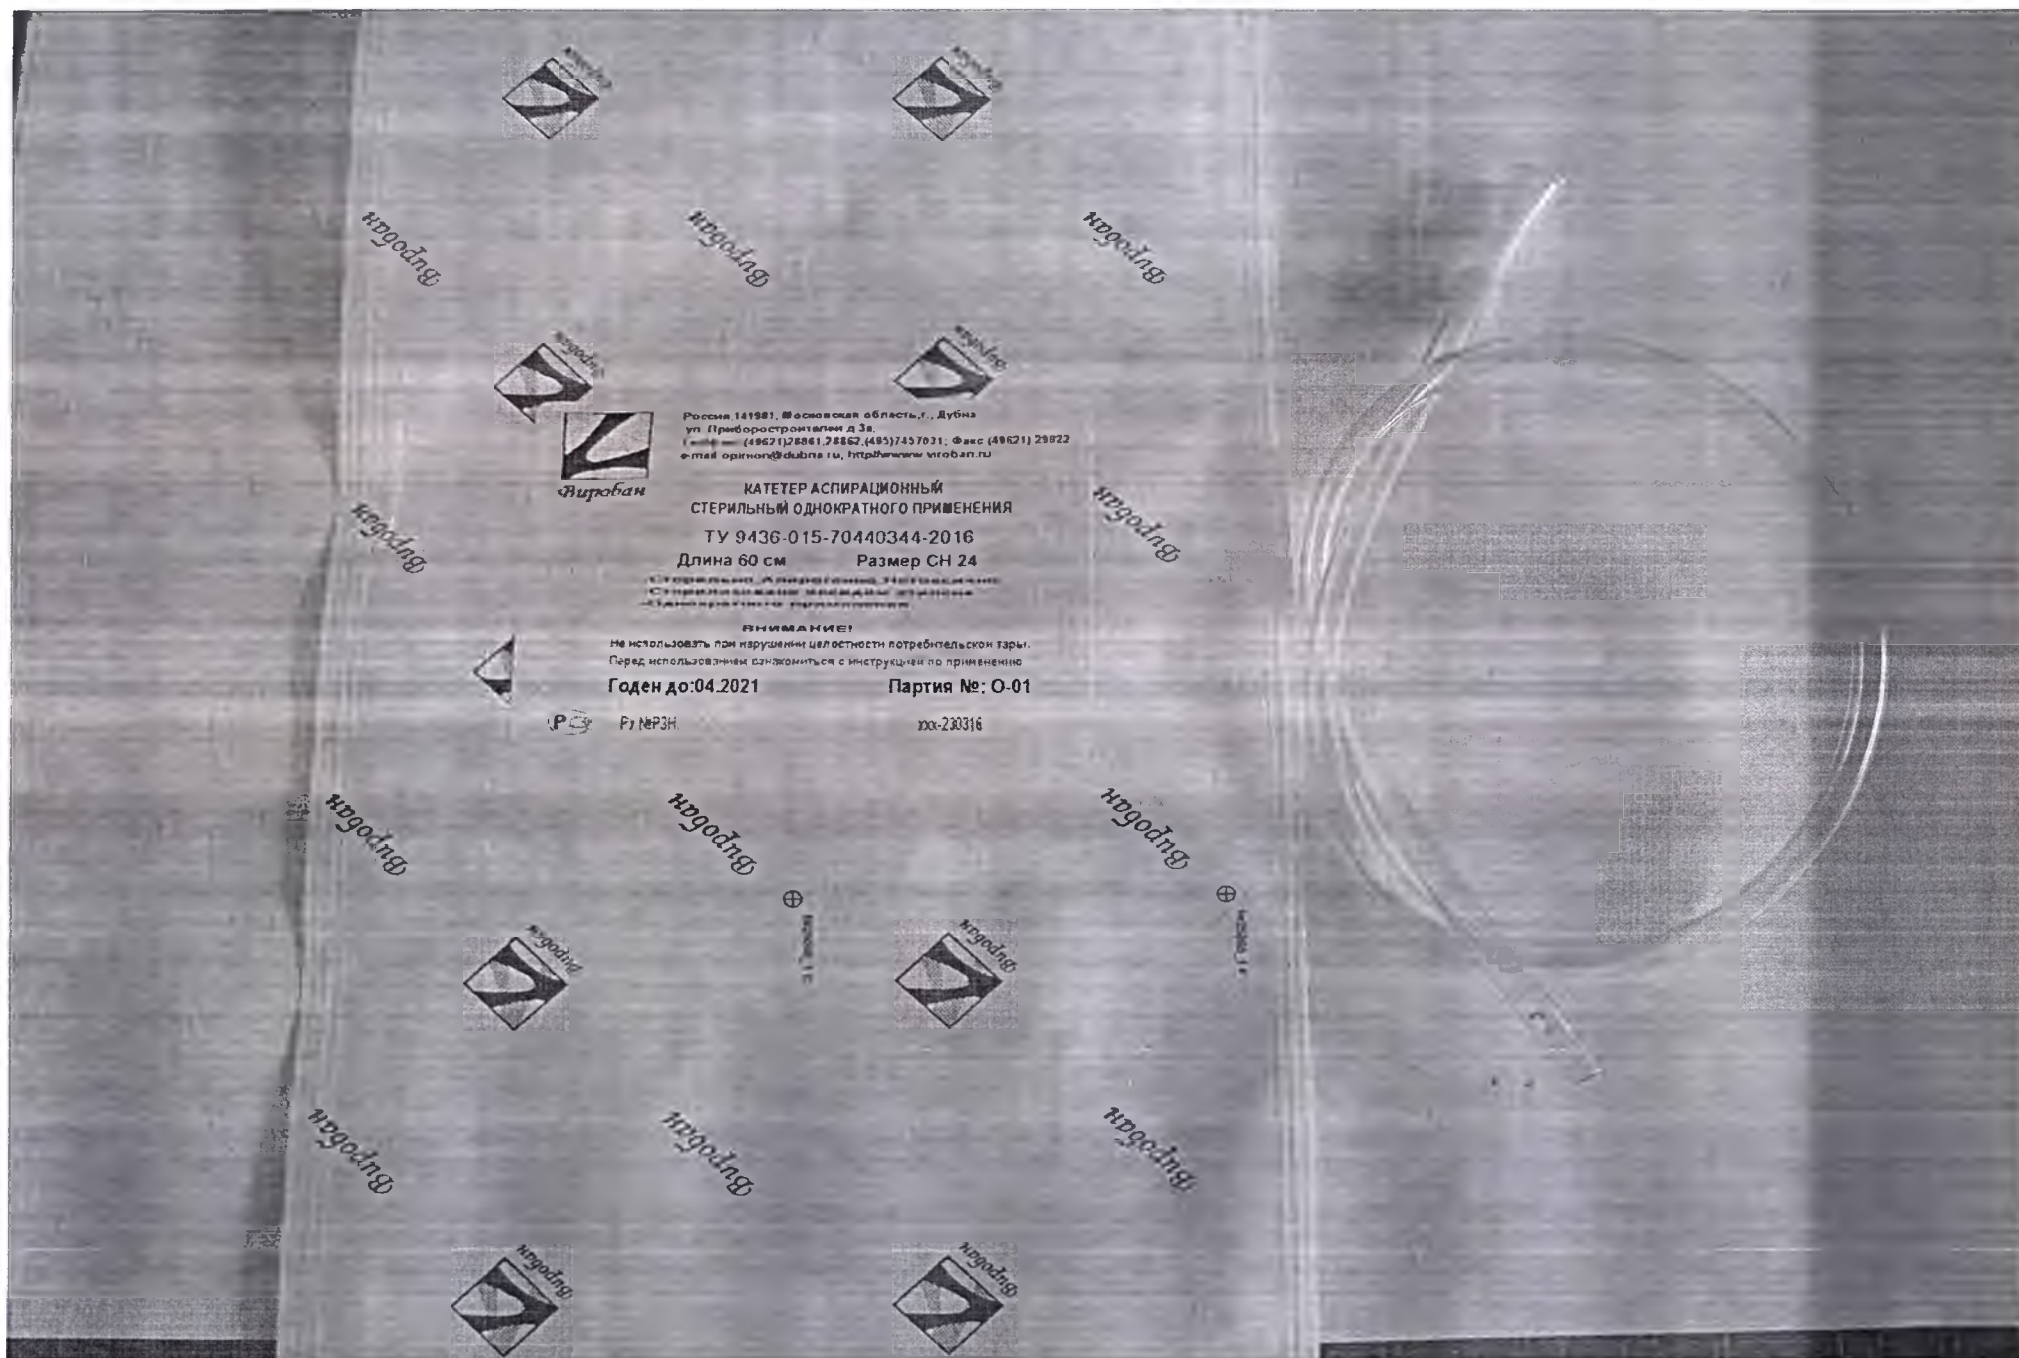

Маркировка потребительской тары Катетеры аспирационные стерильные однократного применения с вакуумконтролем CH24, длина 60 см по ТУ 9436-015-70440344-2016



Виробан

Россия, 141981, Московская область, г. Дубна
ул. Приборостроителей д.3а,
Тел/факс (49621) 28861, 28862, 28863, (495) 7457031;
Факс (49621) 29022
e-mail: opinion@dubna.ru, <http://www.viroban.ru>

**КАТЕТЕР АСПИРАЦИОННЫЙ
СТЕРИЛЬНЫЙ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
с вакуумконтролем**

ТУ 9436-015-70440344-2016

Длина 60 см


Размер CH24

- Стерильно, Апирогенно, Нетоксично**
- Стерилизовано оксидом этилена**
- Однократного применения**

ВНИМАНИЕ!

**Не использовать при нарушении целостности потребительской тары.
Перед использованием ознакомиться с инструкцией по применению.**

Партия №: О-01 Годен до: 04.2021



РУ №РЗН

xxx-230316



Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью ООО « Виробан»

_____ л.

Генеральный директор ООО « Виробан»

_____ В.В. Николаев