

Образцы маркировки

Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М (IgM) к коронавирусу SARS-CoV-2 в сыворотке (плазме) крови человека «SARS-CoV-2 IgM-ИМБИАН-ИФА», ТУ 21.20.23-136-41390295-2021

Комплект №1

SARS-CoV-2 IgM-ИМБИАН-ИФА
Комплект 1

Набор реагентов содержит:

- Иммуносорбент
- K(+/-) инактивированный положительный контрольный образец (1,0 мл)
- K(-) инактивированный отрицательный контрольный образец (2,0 мл)
- ФСБ-Т(х26) концентрат промывочного раствора (30,0 мл)
- РРО - раствор для разведения образцов (12,0 мл)
- КГ(х11) - концентрат конъюгата (1,3 мл)
- РПК - раствор для разведения конъюгата (13,0 мл)
- ТМБ(х11) - концентрат ТМБ (1,3 мл)
- РРТ - раствор для разведения ТМБ (13,0 мл)
- Стоп-реагент (7,0 мл)
- Пленка для заклеивания планшета
- Инструкция по использованию набора реагентов

Для учреждений здравоохранения
Для профессионального применения
Запечатывать не допускается.
Антитела к ВМЧ-1,2, вирусу гепатита С, HBsAg отсутствуют

Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М (IgM) к коронавирусу SARS-CoV-2 в сыворотке (плазме) крови человека «SARS-CoV-2 IgM-ИМБИАН-ИФА», ТУ 21.20.23-136-41390295-2021
(для анализатора автоматического или для ручной постановки анализа)

1 шт	ПУ № XXX XXXX/XXXXXX
1 флакон	
1 флакон	LOT XXXXXX
1 флакон	REF KE-014/96
1 флакон	ГТТГ-ММ-ДД
1 флакон	ГТТГ-ММ-ДД
1 флакон	
3 шт	
1 шт	

Imbian



4 620102 802737

ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Новосибирская область,
рп. Колызово, ул. Садовая 2/7,
2 этаж, помещение 2
8(383)209-34-54, 8-800-600-60-77,
info@imbian.ru









SARS-CoV-2 IgM-ИМБИАН-ИФА ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Иммуносорбент

Запечатанный в фольгированный пакет 96-луночный разборный полистироловый планшет для иммунологических реакций с плоским дном (12 стрипов по 8 лунок) с сорбированными рекомбинантными антигенами спайкового и нуклеокапсидного белков SARS-CoV-2

LOT XXXXXX ГТТГ-ММ-ДД









SARS-CoV-2 IgM-ИМБИАН-ИФА ООО «ИМБИАН ЛАБ»

K(-) – 2,0 мл (Инактивирован)

LOT XXXXXX ГТТГ-ММ-ДД







SARS-CoV-2 IgM-ИМБИАН-ИФА ООО «ИМБИАН ЛАБ»

ФСБ-Т(х26) – 30,0 мл

LOT XXXXXX ГТТГ-ММ-ДД






SARS-CoV-2 IgM-ИМБИАН-ИФА ООО «ИМБИАН ЛАБ»

K(+/-) – 1,0 мл (Инактивирован)

LOT XXXXXX ГТТГ-ММ-ДД







SARS-CoV-2 IgM-ИМБИАН-ИФА ООО «ИМБИАН ЛАБ»

РРО – 12,0 мл

LOT XXXXXX ГТТГ-ММ-ДД






SARS-CoV-2 IgM-ИМБИАН-ИФА ООО «ИМБИАН ЛАБ»

ТМБ(х11) – 1,3 мл

LOT XXXXXX ГТТГ-ММ-ДД







SARS-CoV-2 IgM-ИМБИАН-ИФА ООО «ИМБИАН ЛАБ»

РПК – 13,0 мл

LOT XXXXXX ГТТГ-ММ-ДД






SARS-CoV-2 IgM-ИМБИАН-ИФА ООО «ИМБИАН ЛАБ»

РРТ – 13,0 мл

LOT XXXXXX ГТТГ-ММ-ДД






SARS-CoV-2 IgM-ИМБИАН-ИФА ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Стоп-реагент – 7,0 мл

LOT XXXXXX ГТТГ-ММ-ДД







SARS-CoV-2 IgM-ИМБИАН-ИФА ООО «ИМБИАН ЛАБ»

КГ(х11) – 1,3 мл

LOT XXXXXX ГТТГ-ММ-ДД







Комплект №2

SARS-CoV-2 IgM- ИМБИАН-ИФА

Комплект 2

Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М (IgM) к коронавирусу SARS-CoV-2 в сыворотке (плазме) крови человека «SARS-CoV-2 IgM-ИМБИАН-ИФА», ТУ 21.20.23-136-41390295-2021

(для анализатора автоматического или для ручной постановки анализа)

Набор реагентов содержит:

- 1 Иммуносорбент
- 2 К(+) инактивированный положительный контрольный образец (1,0 мл)
- 3 К(-) инактивированный отрицательный контрольный образец (2,0 мл)
- 4 ФСБ-Т(х26) концентрат промывочного раствора (30,0 мл)
- 5 РРО - раствор для разведения образцов (12,0 мл)
- 6 РК - раствор конъюгата (13,0 мл)
- 7 ТМБ (13,0 мл)
- 8 Стоп-реагент (7,0 мл)
- 9 Пленка для заклеивания планшета
- 10 Инструкция по использованию набора реагентов

1 шт

1 флакон

1 флакон

1 флакон

1 флакон

1 флакон

1 флакон

1 флакон

3 шт

1 шт

ПУ № XXX XXXX/XXXXX

LOT XXXXXX

REF KE-014/96.1

ГТТГ-ММ-ДД

ГТТГ-ММ-ДД

Imbian



ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Новосибирская область,
рп. Кольцово, ул. Садовая 2/7,
2 этаж, помещение 2
8(383)209-34-54, 8-800-600-90-77,
info@imbian.ru

Для учреждений здравоохранения
Для профессионального применения
Замораживать не допускается.
Антитела к ВПЧ-1,2, вирусу гепатита С, HBsAg отсутствуют



SARS-CoV-2 IgM- ИМБИАН-ИФА



Иммуносорбент

Запаянный в фольгированный пакет
96-луночный разборный полистироловый
планшет для иммунологических реакций с
плоским дном (12 стрипов по 8 лунок) с
сорбированными рекомбинантными
антигенами спайкового и нуклеокапсидного
белков SARS-CoV-2

LOT XXXXXX ГТТГ-ММ-ДД



SARS-CoV-2 IgM-ИМБИАН-ИФА

ТМБ – 13,0 мл

LOT XXXXXX

ГТТГ-ММ-ДД



SARS-CoV-2 IgM-ИМБИАН-ИФА

К(-) – 2,0 мл (Инактивирован)

LOT XXXXXX

ГТТГ-ММ-ДД



SARS-CoV-2 IgM-ИМБИАН-ИФА

К(+) – 1,0 мл (Инактивирован)

LOT XXXXXX

ГТТГ-ММ-ДД



SARS-CoV-2 IgM-ИМБИАН-ИФА

ФСБ-Т(х26) – 30,0 мл

LOT XXXXXX

ГТТГ-ММ-ДД



SARS-CoV-2 IgM-ИМБИАН-ИФА

РК – 13,0 мл

LOT XXXXXX

ГТТГ-ММ-ДД



SARS-CoV-2 IgM-ИМБИАН-ИФА

РРО – 12,0 мл

LOT XXXXXX

ГТТГ-ММ-ДД




SARS-CoV-2 IgM-ИМБИАН-ИФА

Стоп-реагент – 7,0 мл

LOT XXXXXX

ГТТГ-ММ-ДД



Генеральный директор ООО «ИМБИАН ЛАБ»

В.В. Осипова

« 24 » 04 2022 г.



НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
РЕГИСТРАЦИИ
И.В. САВИНKOVA

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

2 лист а

Начальник отдела регистрации

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

М.В. Сави

2022 г




Фотографические изображения общего вида

Набора реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М (IgM) к коронавирусу SARS-CoV-2 в сыворотке (плазме) крови человека «SARS-CoV-2 IgM-ИМБИАН-ИФА», ТУ 21.20.23-136-41390295-2021

Комплект 1, серия 220420




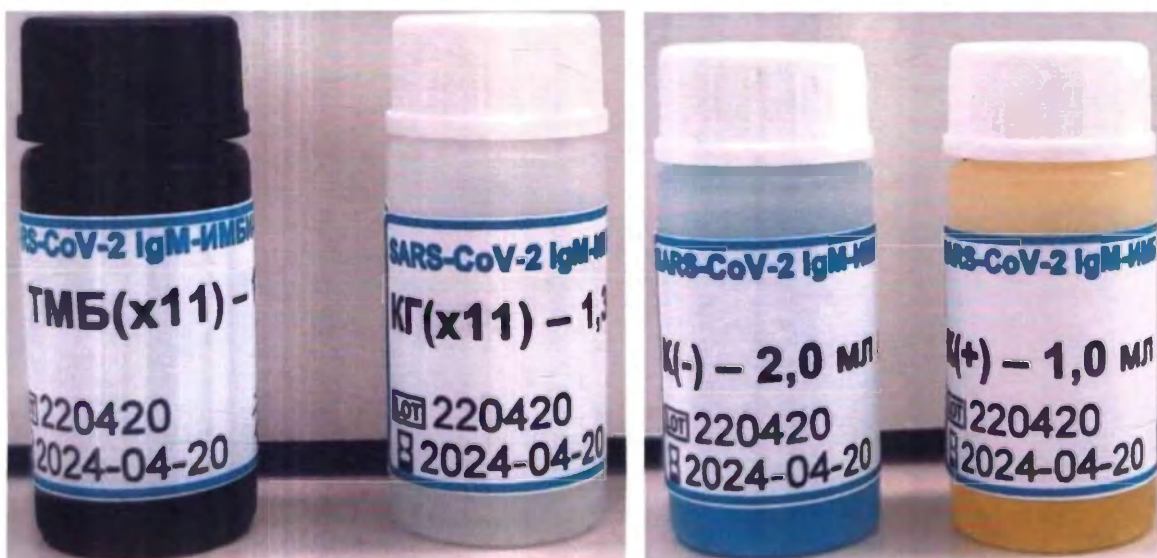



ИНСТРУКЦИЯ

Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М (IgM) к коронавирусу SARS-CoV-2 в сыворотке (плазме) крови человека «SARS-CoV-2 IgM-ИМБИАН-ИФА», ТУ 21.20.23-136-41390295-2021



SARS-CoV-2 IgM-ИМБИАН-ИФА
Комплект 1

Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М (IgM) к коронавирусу SARS-CoV-2 в сыворотке (плазме) крови человека «SARS-CoV-2 IgM-ИМБИАН-ИФА», ТУ 21.20.23-136-41390295-2021
(для анализатора автоматического или для ручной постановки анализа)

Набор реагентов содержит:

Иммуносорбент

- 1) иммобилизованный положительный контрольный образец (1,0 мл)
- 1) иммобилизованный отрицательный контрольный образец (2,0 мл)
- 1) СБ-Т(х26) - концентрат промыточного раствора (30,0 мл)
- 1) РРО - раствор для разведения образца (12,0 мл)
- 1) Т(х11) - концентрат титранта (1,3 мл)
- 1) РРК - раствор для разведения конъюгата (13,0 мл)
- 1) ТМБ(х11) - концентрат ТМБ (1,3 мл)
- 1) РРТ - раствор для разведения ТМБ (13,0 мл)
- 1) Стоп-реагент (7,0 мл)

1) Планка для записывания результатов

2) Инструкция по использованию набора реагентов

- 1 шт
- 1 флакон
- 1 флакон
- 1 флакон
- 1 флакон
- 1 флакон
- 1 флакон
- 1 флакон
- 1 флакон
- 3 шт
- 1 шт

РУ № XXX XXXX/XXXXX

LOT 220421
REF ICE-01486
2023-04-21
2024-04-21




ООО «ИМБИАН ЛАБ»
г. Москва, ул. Садовая 2/1
2 этаж, помещение 2
8(495)350-34-01, 8(495)495-00-77





ИНСТРУКЦИЯ

Набор реагентов для иммуноферментного
выявления иммуноглобулинов класса М (IgM) к
коронавирусу SARS-CoV-2 в сыворотке (плазме)
крови человека «SARS-CoV-2 IgM-ИМБИАН-ИФА», ТУ 21.20.23-136-41390295-2021



SARS-CoV-2 IgM-ИМБИАН-ИФА

Комплект 2

Набор реагентов для иммуноферментного выявления
иммуноглобулинов класса М (IgM) к коронавирусу SARS-CoV-2
в сыворотке (плазме) крови человека «SARS-CoV-2 IgM-ИМБИАН-ИФА», ТУ 21.20.23-136-41390295-2021
(для анализа автоматического или для ручной постановки анализа)

Набор реагентов содержит:

Иммуносорбент

1 (+) иммуносорбентный положительный контрольный образец (1,0 мл)

1 (-) иммуносорбентный отрицательный контрольный образец (2,0 мл)

ОСБ-Т(x26) концентрат промывочного раствора (30,0 мл)

PPO - раствор для разведения образца (12,0 мл)

ПК - раствор субстрата (13,0 мл)

ТМБ (13,0 мл)

Стоп-реагент (7,0 мл)

Инструкция для заключения результата

Инструкция по использованию набора реагентов

Инструкция по использованию набора реагентов

Инструкция по использованию набора реагентов

Инструкция по использованию набора реагентов

Инструкция по использованию набора реагентов

Инструкция по использованию набора реагентов

Инструкция по использованию набора реагентов

Инструкция по использованию набора реагентов

Инструкция по использованию набора реагентов

Инструкция по использованию набора реагентов

Инструкция по использованию набора реагентов

Инструкция по использованию набора реагентов

Инструкция по использованию набора реагентов

Инструкция по использованию набора реагентов

Инструкция по использованию набора реагентов

Инструкция по использованию набора реагентов

Инструкция по использованию набора реагентов

Инструкция по использованию набора реагентов

Инструкция по использованию набора реагентов

Инструкция по использованию набора реагентов

Инструкция по использованию набора реагентов

Инструкция по использованию набора реагентов

Инструкция по использованию набора реагентов

Инструкция по использованию набора реагентов

Инструкция по использованию набора реагентов

Инструкция по использованию набора реагентов

Инструкция по использованию набора реагентов

Инструкция по использованию набора реагентов

Инструкция по использованию набора реагентов

Инструкция по использованию набора реагентов

Инструкция по использованию набора реагентов

Инструкция по использованию набора реагентов

Инструкция по использованию набора реагентов

Инструкция по использованию набора реагентов

Инструкция по использованию набора реагентов

Инструкция по использованию набора реагентов

Инструкция по использованию набора реагентов

Инструкция по использованию набора реагентов

Инструкция по использованию набора реагентов

Инструкция по использованию набора реагентов

Инструкция по использованию набора реагентов

Инструкция по использованию набора реагентов

Инструкция по использованию набора реагентов

Инструкция по использованию набора реагентов

Инструкция по использованию набора реагентов

Инструкция по использованию набора реагентов

Инструкция по использованию набора реагентов

Инструкция по использованию набора реагентов

Инструкция по использованию набора реагентов

Инструкция по использованию набора реагентов

Инструкция по использованию набора реагентов

Инструкция по использованию набора реагентов

Инструкция по использованию набора реагентов

Инструкция по использованию набора реагентов

Инструкция по использованию набора реагентов

РУ № XXX XXXX/XXXXX

LOT 220420

REF KS-014/05.1

2023-04-30

2024-04-30

Imbian

LOT 220420

REF KS-014/05.1

2023-04-30

2024-04-30

ИМБИАН-ИФА

Иммуносорбент

Иммуносорбент

Иммуносорбент

Иммуносорбент

Иммуносорбент

Иммуносорбент

Иммуносорбент

Иммуносорбент

Иммуносорбент

Иммуносорбент

Иммуносорбент

Иммуносорбент

Иммуносорбент

Иммуносорбент

Иммуносорбент

Иммуносорбент

Иммуносорбент

Иммуносорбент

Иммуносорбент

Иммуносорбент

Иммуносорбент

Иммуносорбент

Иммуносорбент

Иммуносорбент

Иммуносорбент

Иммуносорбент

Иммуносорбент

Иммуносорбент

Иммуносорбент

Иммуносорбент


Иммуносорбент





ИНСТРУКЦИЯ

Набор реагентов для иммуноферментного
выявления иммуноглобулинов класса М (IgM) к
коронавирусу SARS-CoV-2 в сыворотке (плазме)
крови человека «SARS-CoV-2 IgM-ИМБИАН-ИФА»,
ИФА, ТУ 21.20.23-136-41398295-2021



SARS-CoV-2 IgM-ИМБИАН-ИФА
Комплект 2

Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М (IgM) к коронавирусу SARS-CoV-2 в сыворотке (плазме) крови человека «SARS-CoV-2 IgM-ИМБИАН-ИФА», ТУ 21.20.23-136-41398295-2021
(для анализатора автоматического или для ручной постановки анализа)

Набор реагентов содержит:

- 1 Иммуносорбент
- 2 K(+) индентифицированный положительный контрольный образец (1,0 мл)
- 3 K(-) индентифицированный отрицательный контрольный образец (2,0 мл)
- 4 ФСБ-Т(x26) концентрат промыточного раствора (30,0 мл)
- 5 PPO - раствор для развития образца (12,0 мл)
- 6 PK - раствор мытьев (13,0 мл)
- 7 ТМБ (13,0 мл)
- 8 Стоп-реагент (7,0 мл)
- 9 Пластина для зачитывания результатов
- 10 Инструкция по использованию набора реагентов

1 шт 1 флакон 1 флакон 1 флакон 1 флакон 1 флакон 1 флакон 1 флакон 3 шт 1 шт

ПУ № XXX XXXX/XXXXX

LOT 220421
EXP 05-01-2025
2023-04-21
2024-04-21

Imbian

ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630550, Новосибирская область,
гп. Калинин, ул. Савинкова 2/7
3 этаж, корпусов 2
8(383)229-04-04, 8(800)420-00-77
info@imbian.ru



Генеральный директор ООО «ИМБИАН ЛАБ»

« 24 » 04 2022 г.

В.В. Осипова

ВНУШАЛЬНИК ОТДЕЛА
РЕГИСТРАЦИИ
М.В. САВИНKOVA



Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

лист 22

Начальник отдела регистрации
ООО «ИМБИАН ЛАБ»

М.В. Савинова

"27"

205 2022 г.

