




Набор реагентов для определения общей активности лактатдегидрогеназы кинетическим методом в сыворотке крови
(ЛАКТАТДЕГИДРОГЕНАЗА ДиаС) по ТУ 9398-104-48813770-2015

Комплектация 1

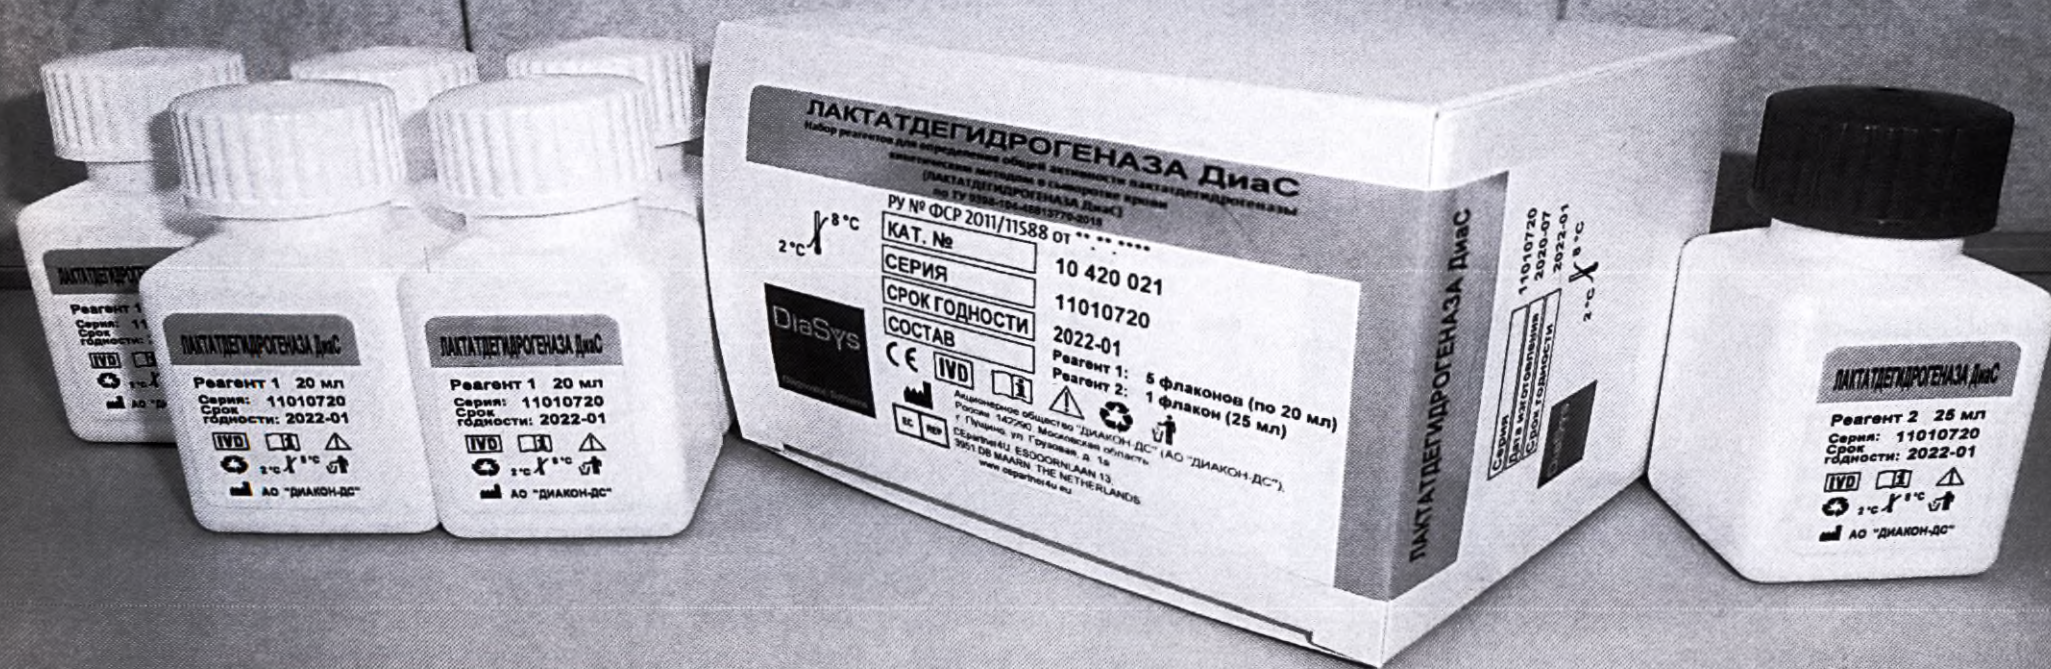

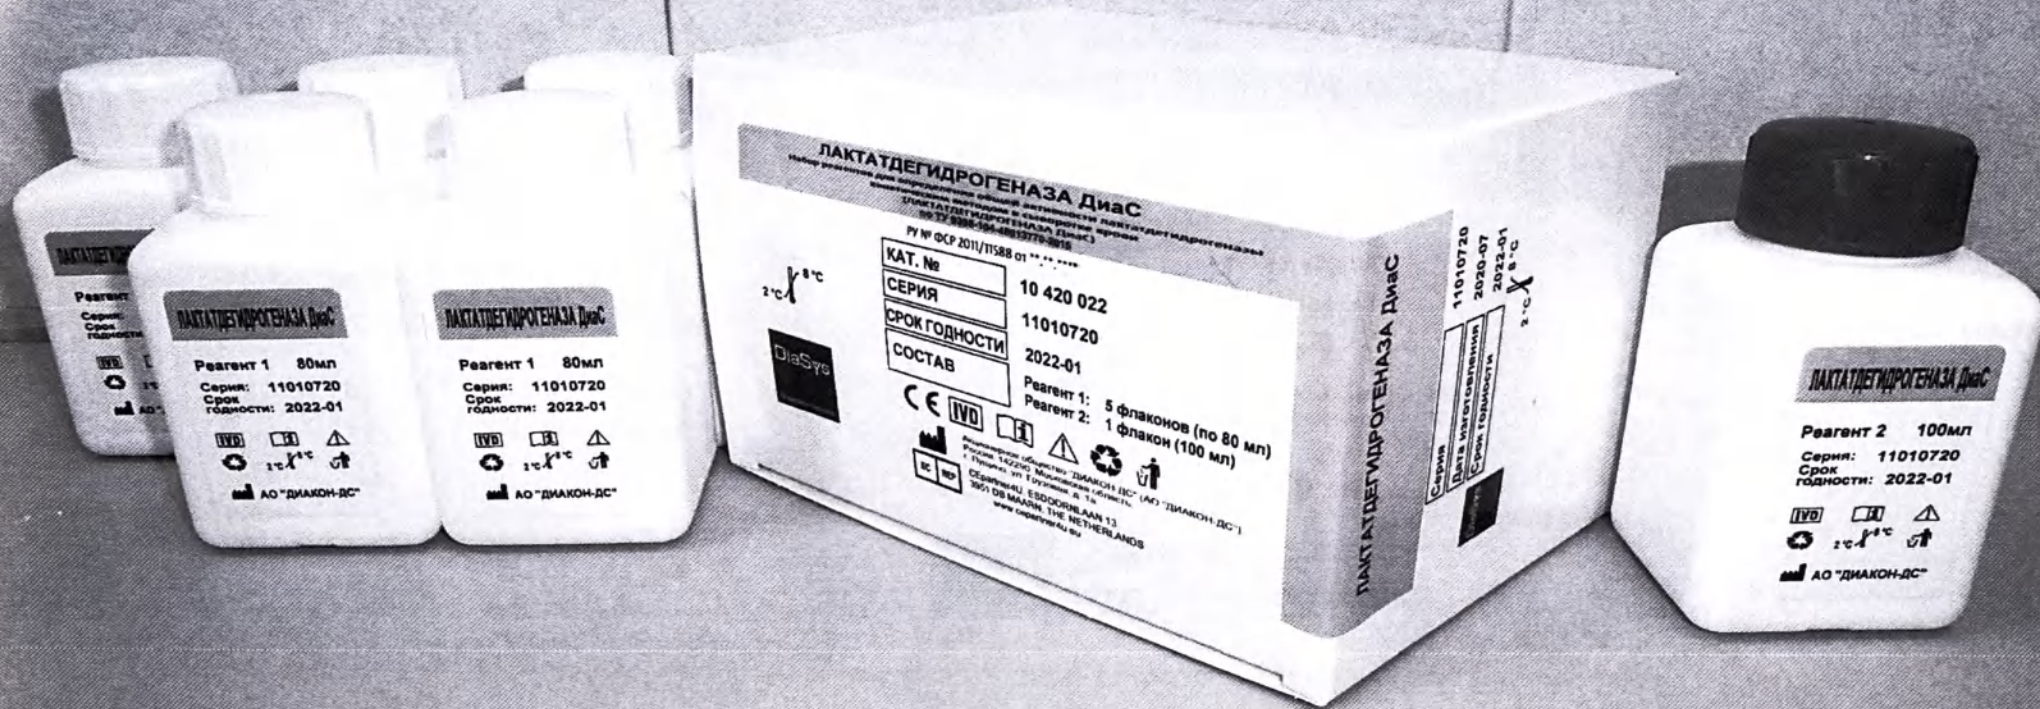


Набор реагентов для определения общей активности лактатдегидрогеназы кинетическим методом в сыворотке крови
(ЛАКТАТДЕГИДРОГЕНАЗА ДиаС) по ТУ 9398-104-48813770-2015

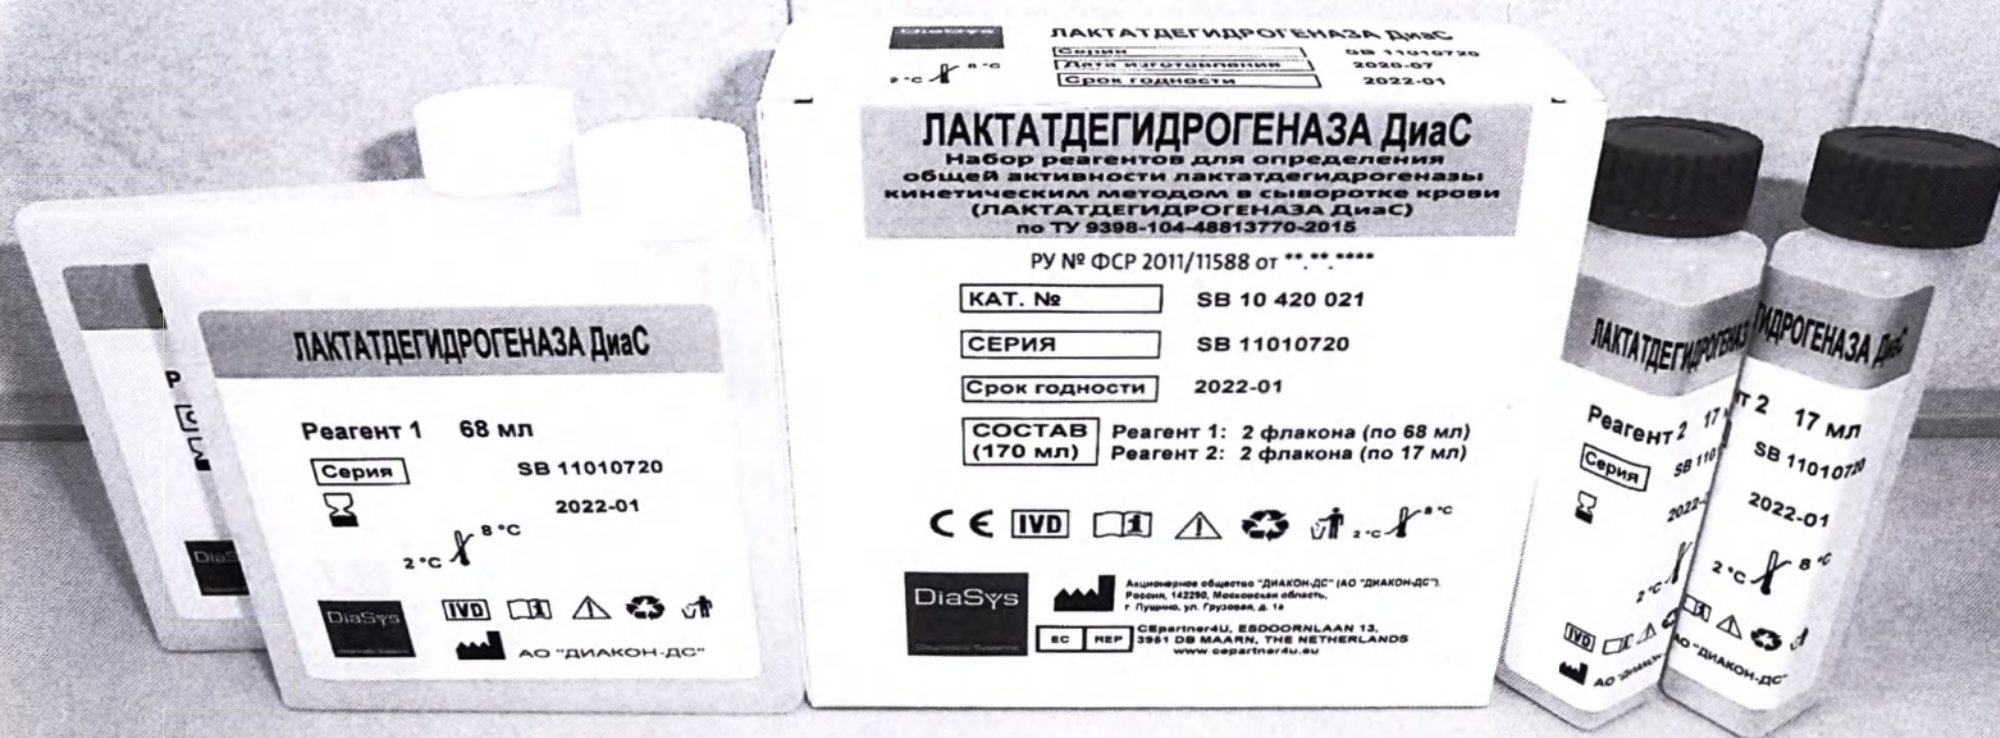







Набор реагентов для определения общей активности лактатдегидрогеназы кинетическим методом в сыворотке крови
(ЛАКТАТДЕГИДРОГЕНАЗА ДиаС) по ТУ 9398-104-48813770-2015



Внешний вид

Набор реагентов для определения общей активности лактатдегидрогеназы кинетическим методом в сыворотке крови
(ЛАКТАТДЕГИДРОГЕНАЗА ДиаС) по ТУ 9398-104-48813770-2015

8



Внешний вид

Набор реагентов для определения общей активности лактатдегидрогеназы кинетическим методом в сыворотке крови
(ЛАКТАТДЕГИДРОГЕНАЗА ДиаС) по ТУ 9398-104-48813770-2015



Набор реагентов для определения общей активности лактатдегидрогеназы кинетическим методом в сыворотке крови
(ЛАКТАТДЕГИДРОГЕНАЗА ДиаС) по ТУ 9398-104-48813770-2015

10



ЛАКТАТДЕГИДРОГЕНАЗА ДиаС

Реагент 1 38 мл

Серия S 11010720

Срок годности 2022-01

IVD АО "ДИАКОН-ДС"

ЛАКТАТДЕГИДРОГЕНАЗА ДиаС
Набор реагентов для определения
общей активности лактатдегидрогеназы
кинетическим методом в сыворотке крови
(ЛАКТАТДЕГИДРОГЕНАЗА ДиаС)
по ТУ 9398-104-48813770-2015

ПУ № ФСР 2011/11588 от **..****

САПФИР 400-24 (*** тестов)

КАТ. № S 24 10 420 021

СЕРИЯ S 11010720

Срок годности 2022-01

СОСТАВ Реагент 1: 4 флакона (по 38 мл)
Реагент 2: 2 флакона (по 22 мл)




CE IVD







Внешний вид
реактивов для определения общей активности лактатдегидрогеназы кинетическим методом в сыворотке крови
(ЛАКТАТДЕГИДРОГЕНАЗА ДиаС) по ТУ 9398-104-48813770-2015

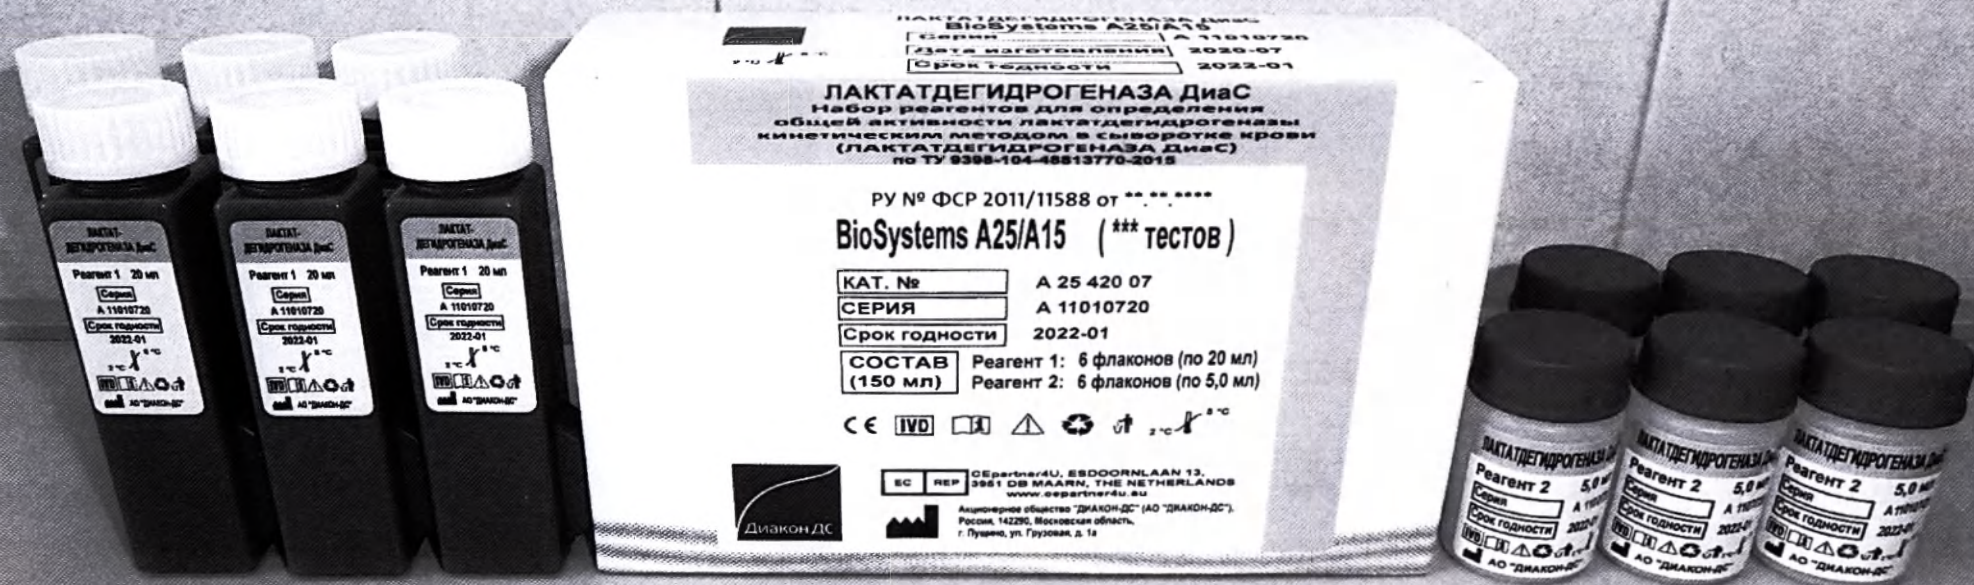


внешний вид
набор реагентов для определения общей активности лактатдегидрогеназы кинетическим методом в сыворотке крови
(ЛАКТАТДЕГИДРОГЕНАЗА ДиаС) по ТУ 9398-104-48813770-2015

15



Набор реагентов для определения общей активности лактатдегидрогеназы кинетическим методом в сыворотке крови
(ЛАКТАТДЕГИДРОГЕНАЗА ДиаС) по ТУ 9398-104-48813770-2015


16

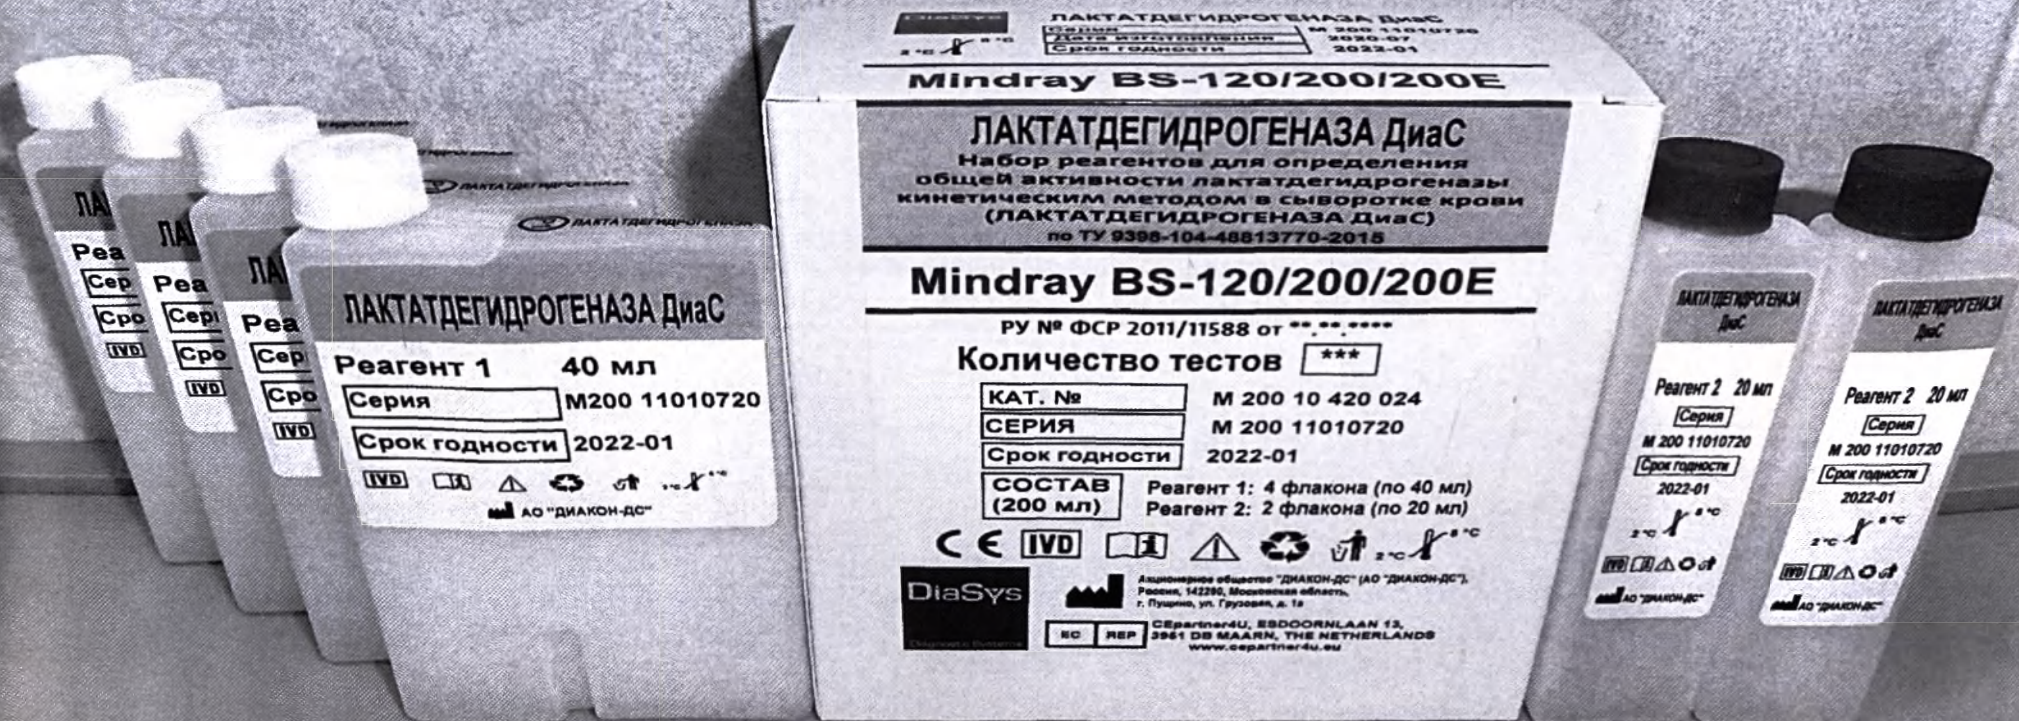



Набор реагентов для определения общей активности лактатдегидрогеназы кинетическим методом в сыворотке крови
(ЛАКТАТДЕГИДРОГЕНАЗА ДиаС) по ТУ 9398-104-48813770-2015


диз 18

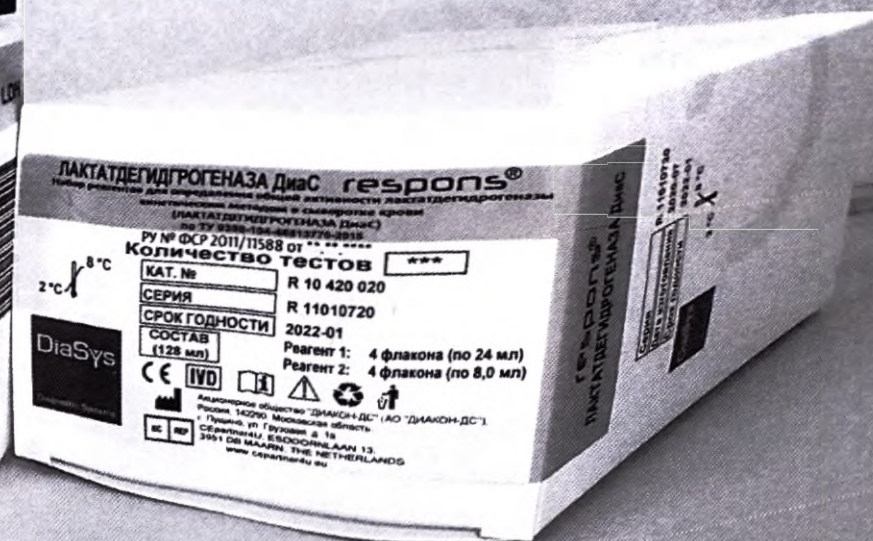




Набор реагентов для определения общей активности лактатдегидрогеназы кинетическим методом в сыворотке крови
(ЛАКТАТДЕГИДРОГЕНАЗА ДиаС) по ТУ 9398-104-48813770-2015

ция 20

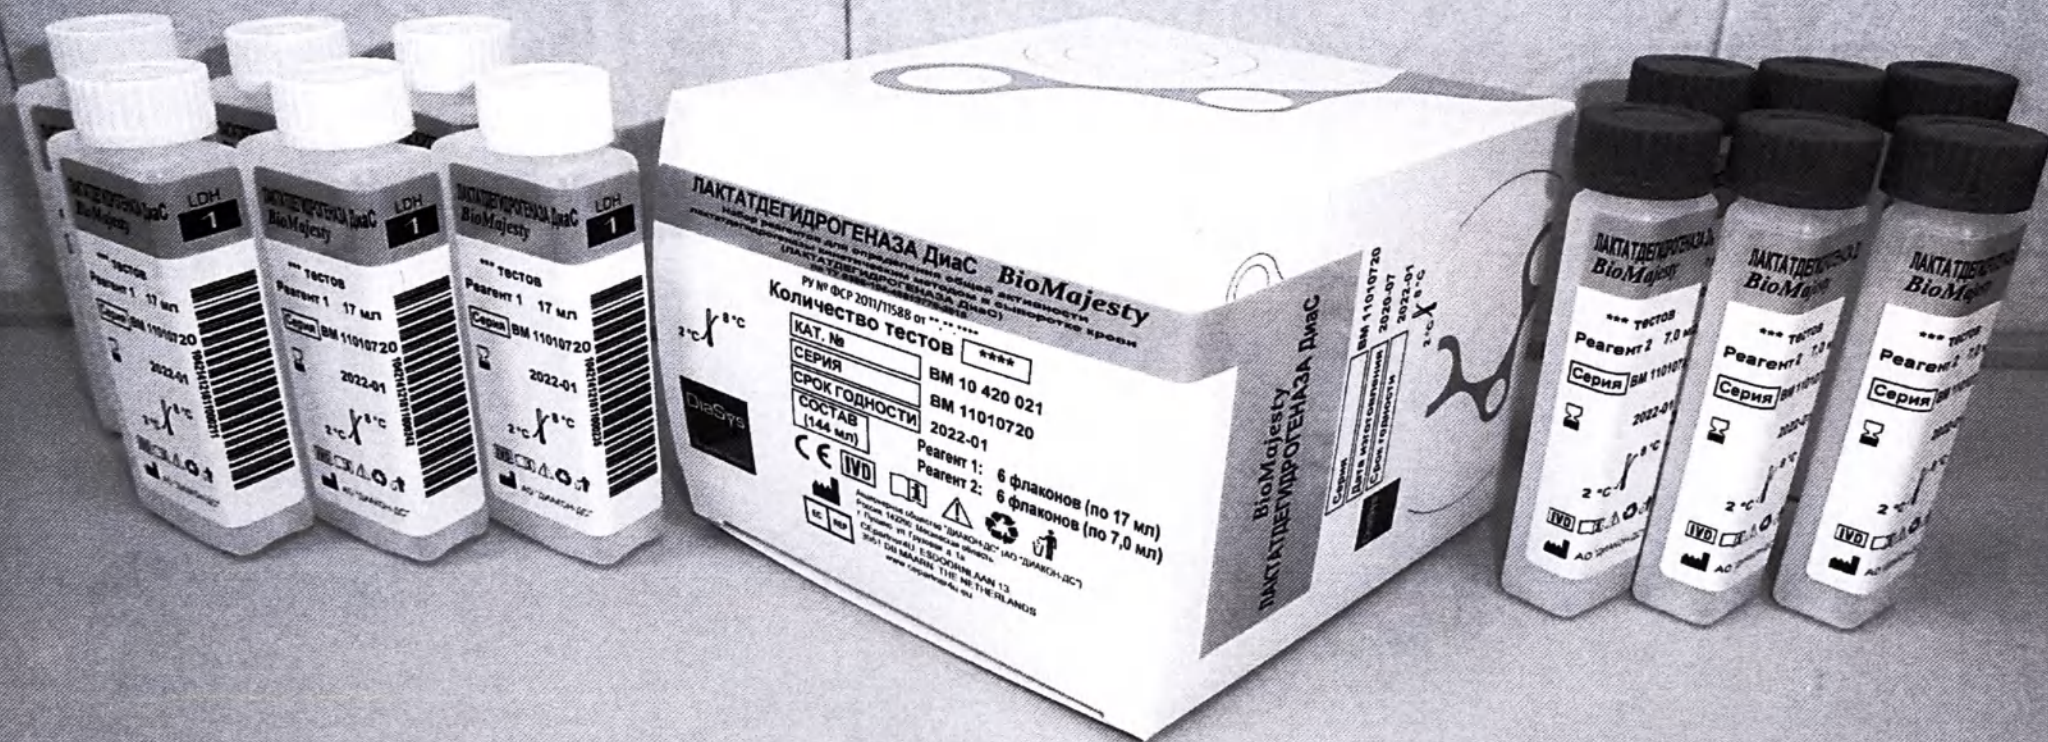



Набор реагентов для определения общей активности лактатдегидрогеназы кинетическим методом в сыворотке крови
(ЛАКТАТДЕГИДРОГЕНАЗА ДиаС) по ТУ 9398-104-48813770-2015

дняя 21

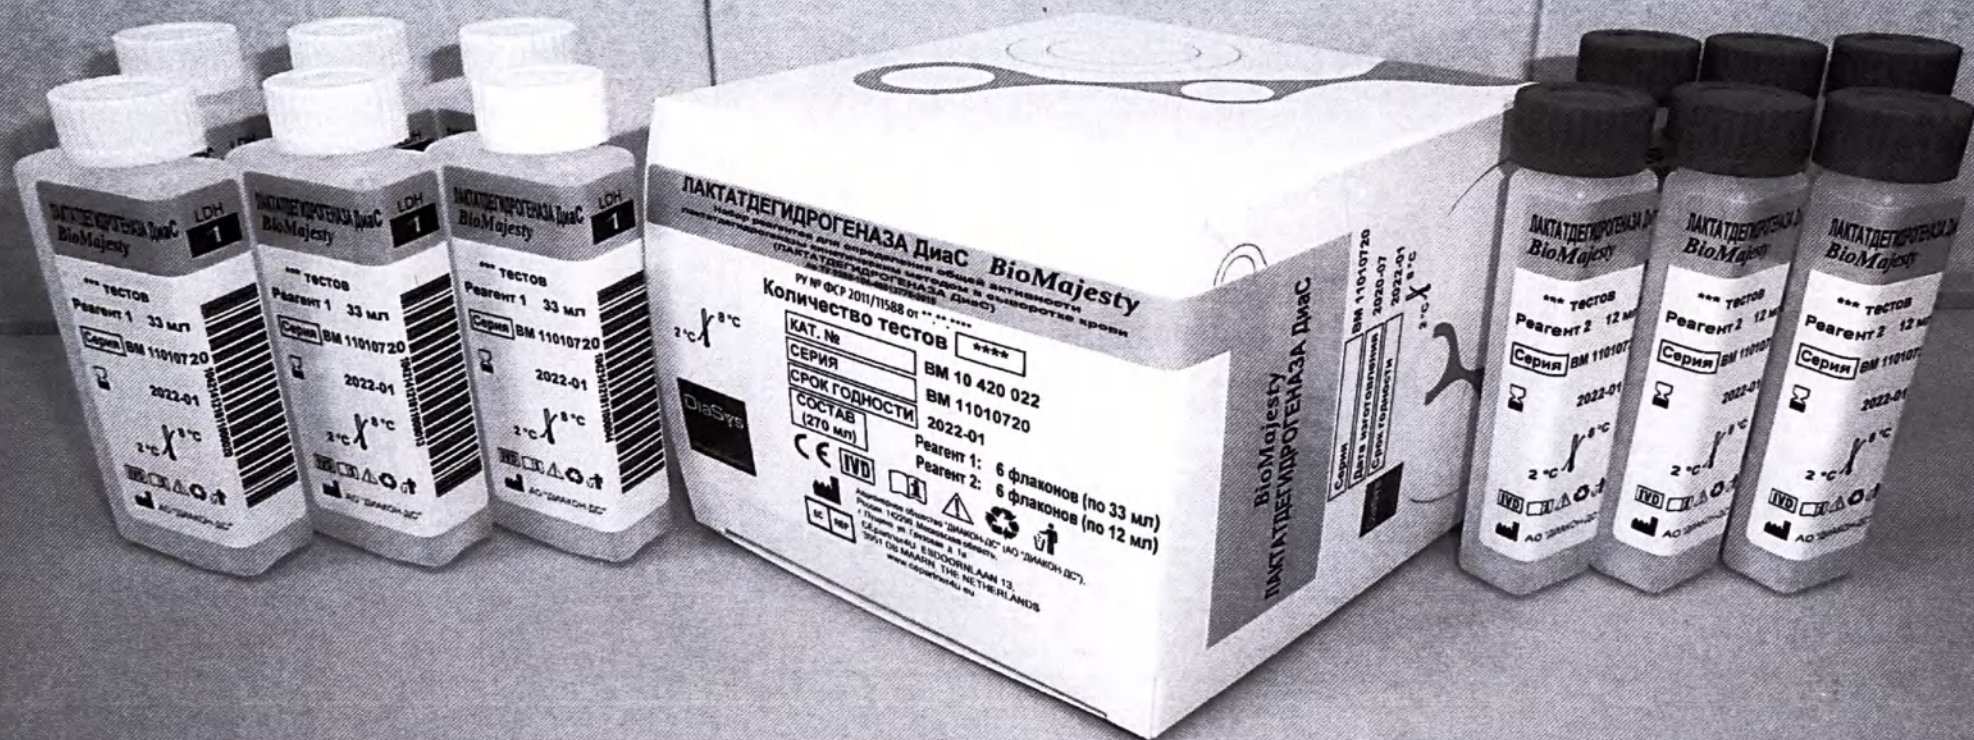

Набор реагентов для определения общей активности лактатдегидрогеназы кинетическим методом в сыворотке крови
(ЛАКТАТДЕГИДРОГЕНАЗА ДиаС) по ТУ 9398-104-48813770-2015

ция 22

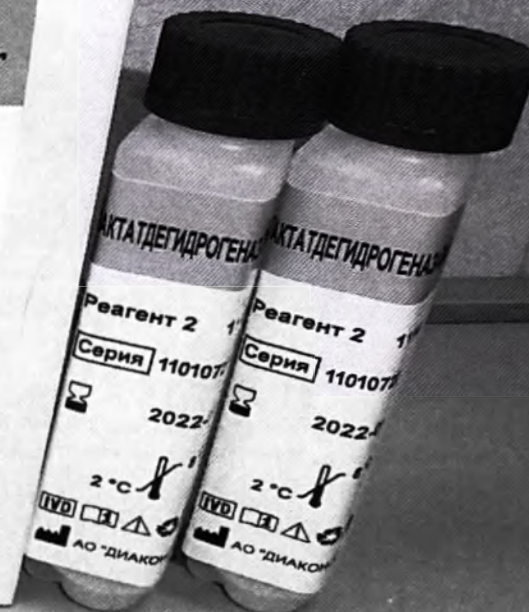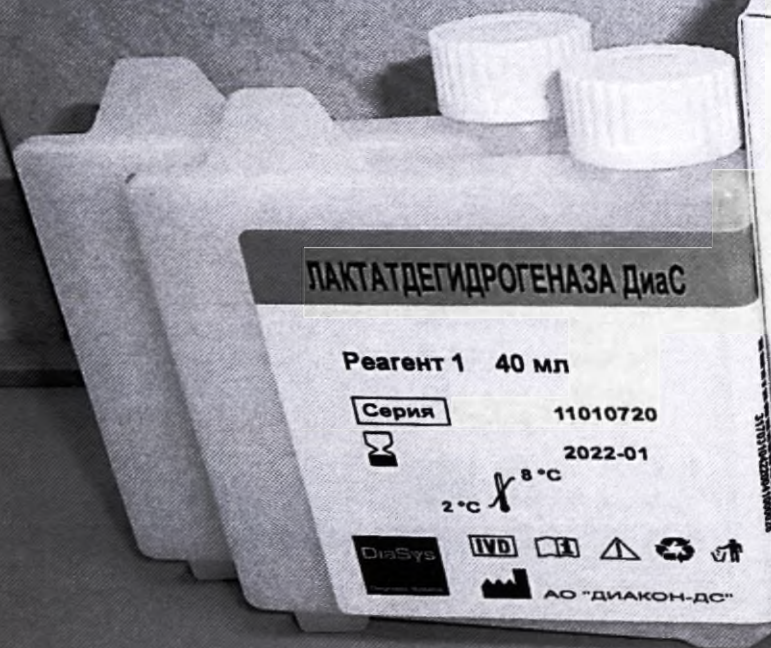



ЛАКТАТДЕГИДРОГЕНАЗА ДиаС

Реагент 1 39 мл

Серия 11010720
2022-01

2°C



IVD

ISO 13485

CE

REACH

RoHS

WEEE

АО "ДИАКОН-ДС"

ЛАКТАТДЕГИДРОГЕНАЗА ДиаС

Набор реагентов для определения
общей активности лактатдегидрогеназы
кинетическим методом в сыворотке крови
(ЛАКТАТДЕГИДРОГЕНАЗА ДиаС)
по ТУ 9398-104-48813770-2015

ПУ № ФСР 2011/11588 от **.*.***

КАТ. № **.*.***

СЕРИЯ 11010720

Срок годности 2022-01

Состав Реагент 1: 10 флаконов (по 39 мл)
Реагент 2: 10 флаконов (по 13 мл)



Акционерное общество "ДИАКОН-ДС" (АО "ДИАКОН-ДС"),
Россия, 142280, Московская область,
г. Пушкино, ул. Грузовая, д. 1а

CEpartner4U, ESDOORNLAAN 13,
3961 DB MAARN, THE NETHERLANDS
www.cepartner4u.eu

Реагент 2

Серия 11010720

2022-01

2°C

IVD

АО "ДИАКОН-ДС"

Реагент 2

Серия 11010720

2022-01

2°C

IVD

АО "ДИАКОН-ДС"

Реагент 2

Серия 11010720

2022-01

2°C

IVD

АО "ДИАКОН-ДС"

Реагент 2

Серия 11010720

2022-01

2°C

IVD

АО "ДИАКОН-ДС"

Реагент 2

Серия 11010720

2022-01

2°C

IVD

АО "ДИАКОН-ДС"

Реагент 2

Серия 11010720

2022-01


2°C

IVD

АО "ДИАКОН-ДС"


Набор реагентов для определения общей активности лактатдегидрогеназы кинетическим методом в сыворотке крови
(ЛАКТАТДЕГИДРОГЕНАЗА ДиаС) по ТУ 9398-104-48813770-2015

ция 24

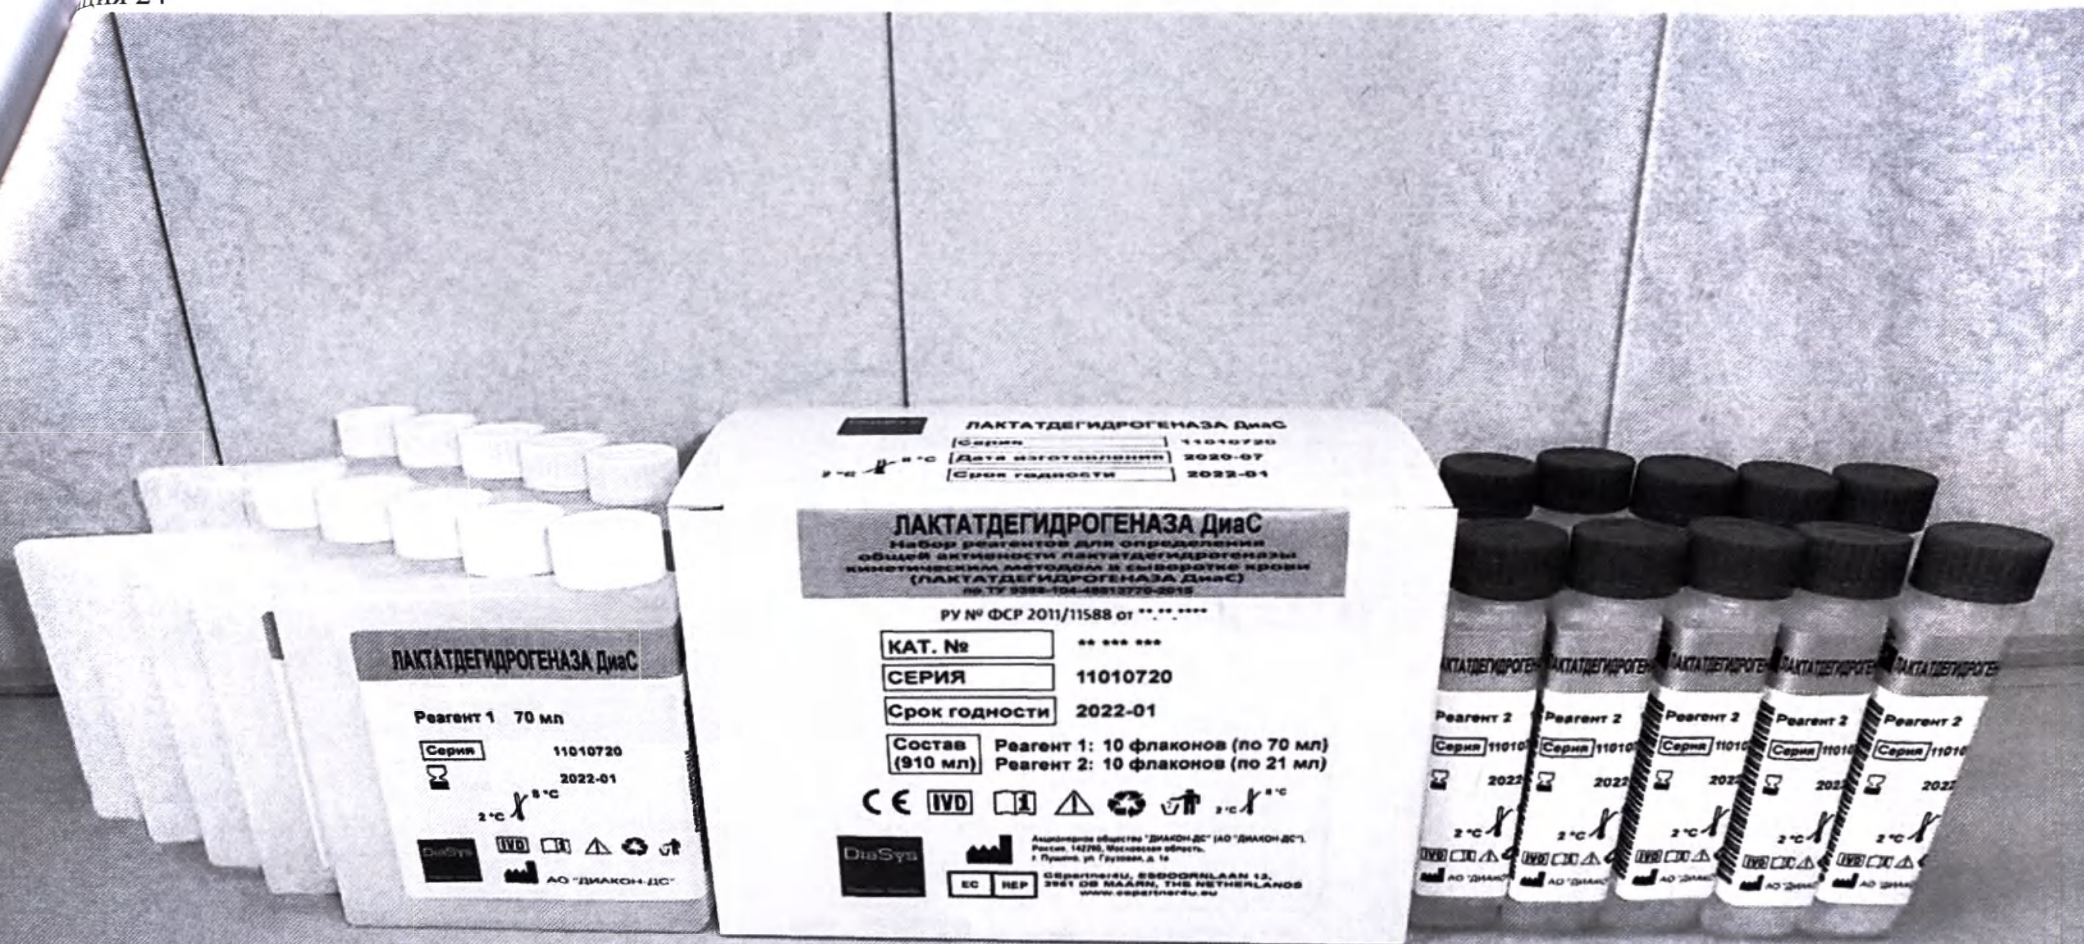


Набор реагентов для определения общей активности лактатдегидрогеназы кинетическим методом в сыворотке крови
(ЛАКТАТДЕГИДРОГЕНАЗА ДиаС) по ТУ 9398-104-48813770-2015

ция 25

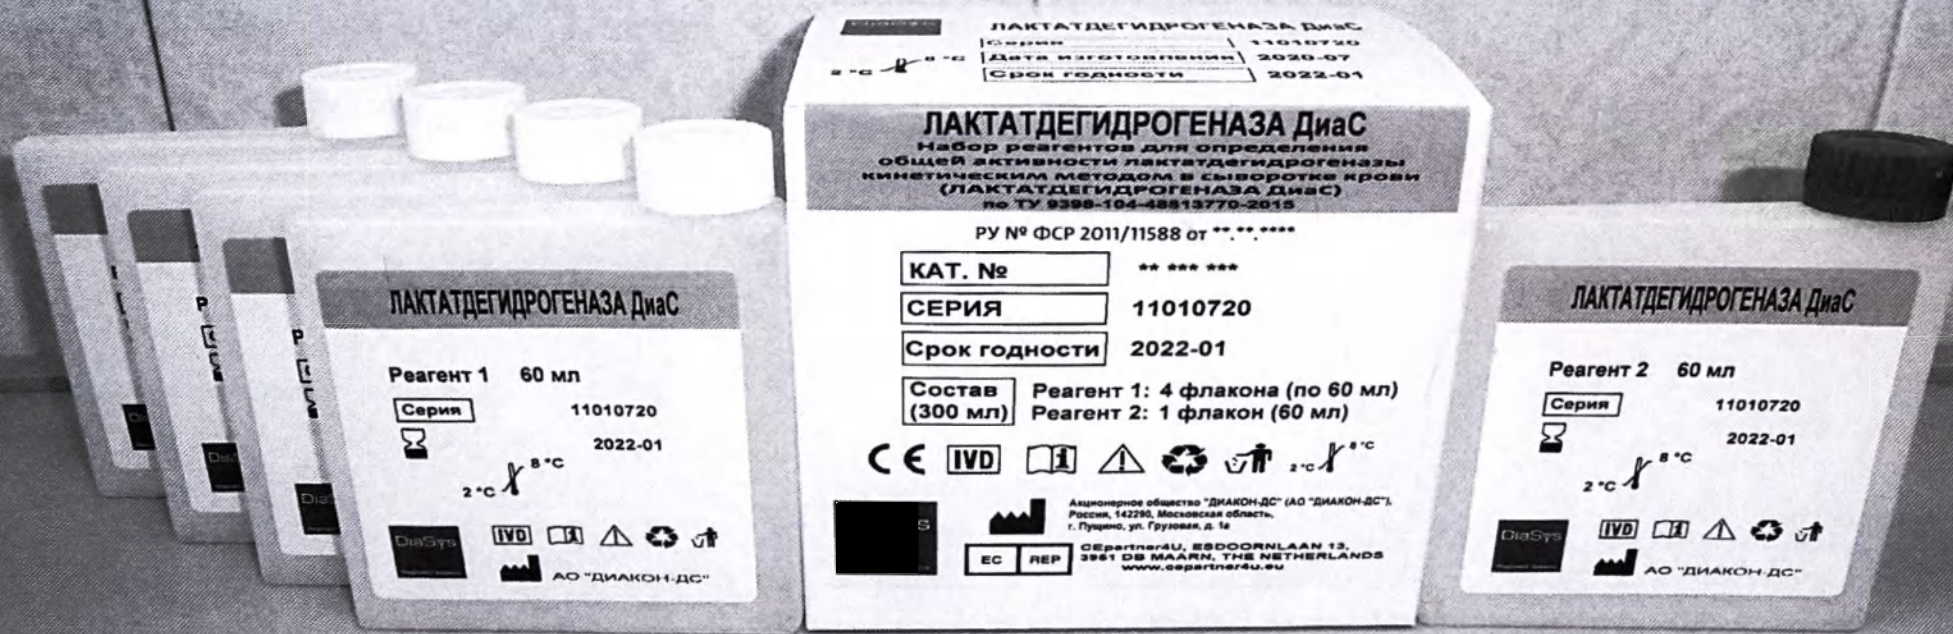



Набор реагентов для определения общей активности лактатдегидрогеназы кинетическим методом в сыворотке крови
(ЛАКТАТДЕГИДРОГЕНАЗА ДиаС) по ТУ 9398-104-48813770-2015

ция 25

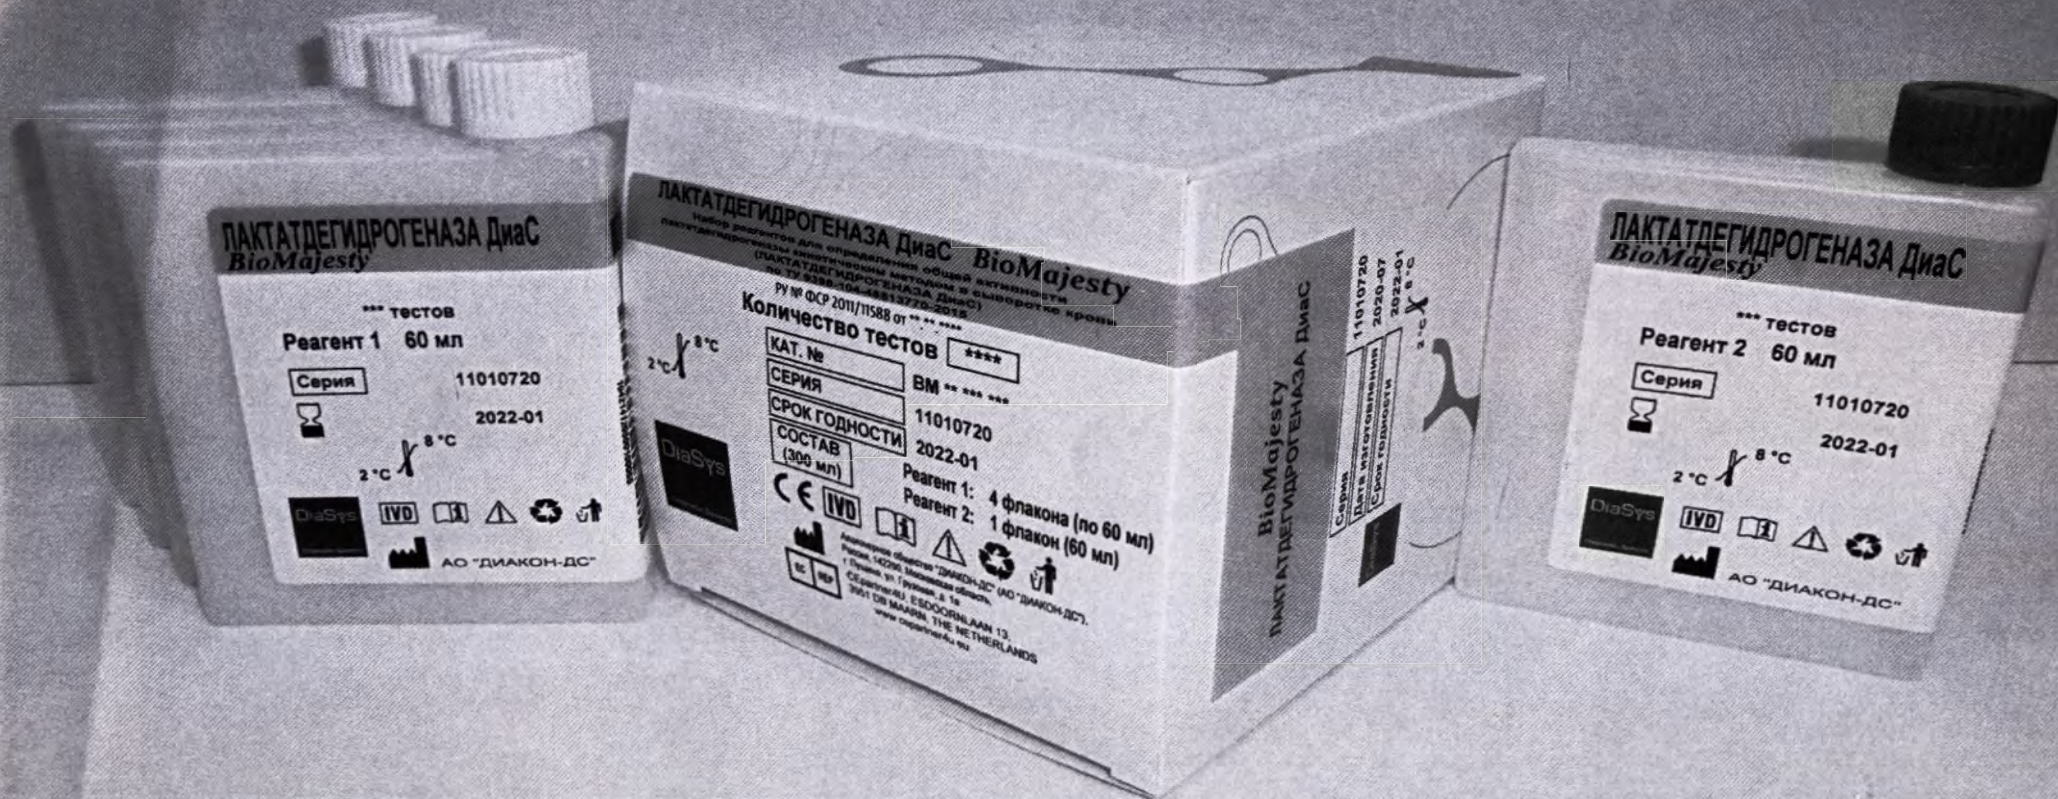

Набор реагентов для определения общей активности лактатдегидрогеназы кинетическим методом в сыворотке крови
(ЛАКТАТДЕГИДРОГЕНАЗА ДиаС) по ТУ 9398-104-48813770-2015

ция 26

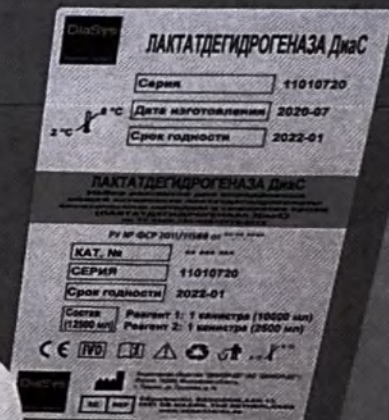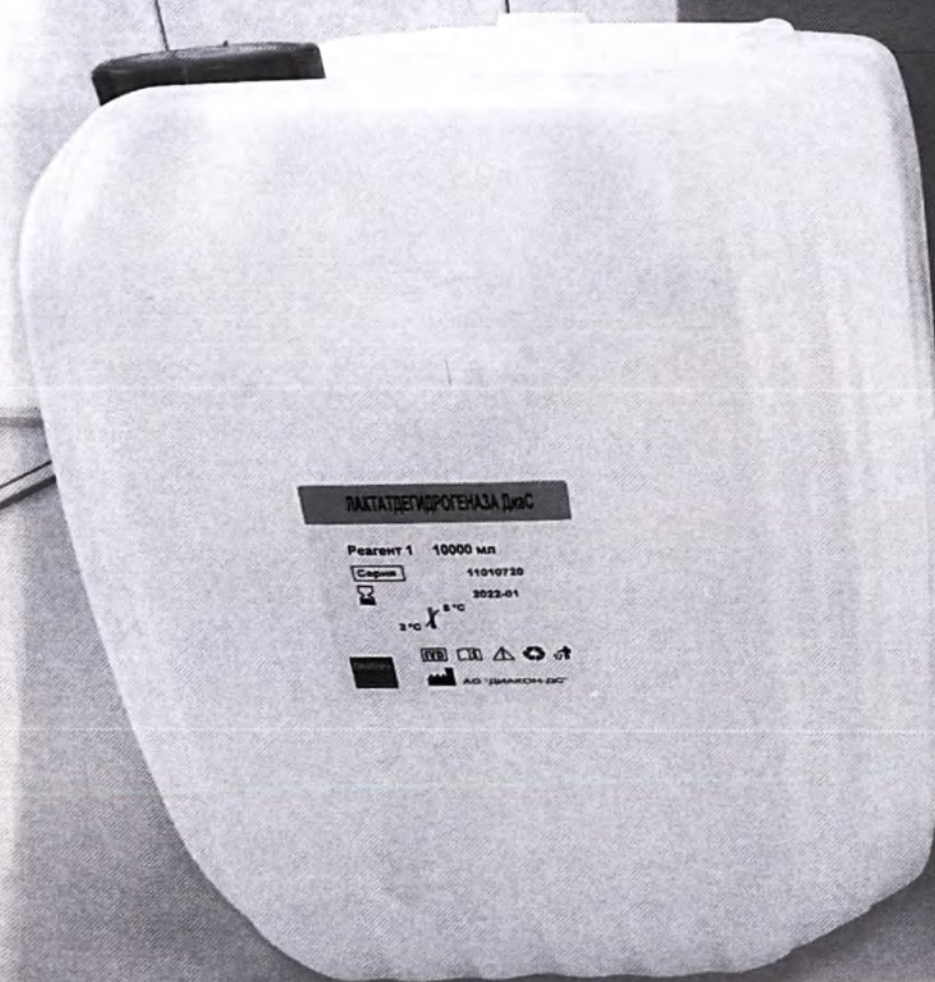

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 27

Генеральный директор
АО «ДИАКОН-ДС»

Т.Ю. Корзун

