

**Набор реагентов для качественного выявления антигенов
SARS-CoV-2, вирусов гриппа типов А и В в клиническом материале
человека методом иммунохроматографического анализа
«GT CoV-Influ antigen test», партия 202203-87**

Форма комплектации 1

LOT 202203-87

Состав набора:

 2022-03

Тестовая кассета: 25 шт.

 2024-03

Пробирка с буфером: 25шт. по 330 мкл

 25

Инструкция по применению: 1 шт.

 -30...+30

Паспорт качества: 1 шт.



Только для *in vitro* диагностики



Только для профессионального применения

ООО «ТестГен»

432072 Россия, г. Ульяновск, 44-й Инженерный проезд, дом 9, офис 13


Тел.: +7 (499) 705-03-75


info@testgen.ru


ПУ № ____ / ____





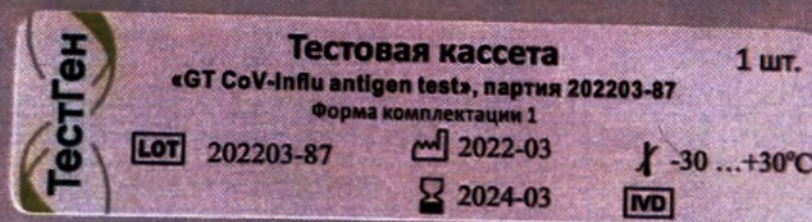

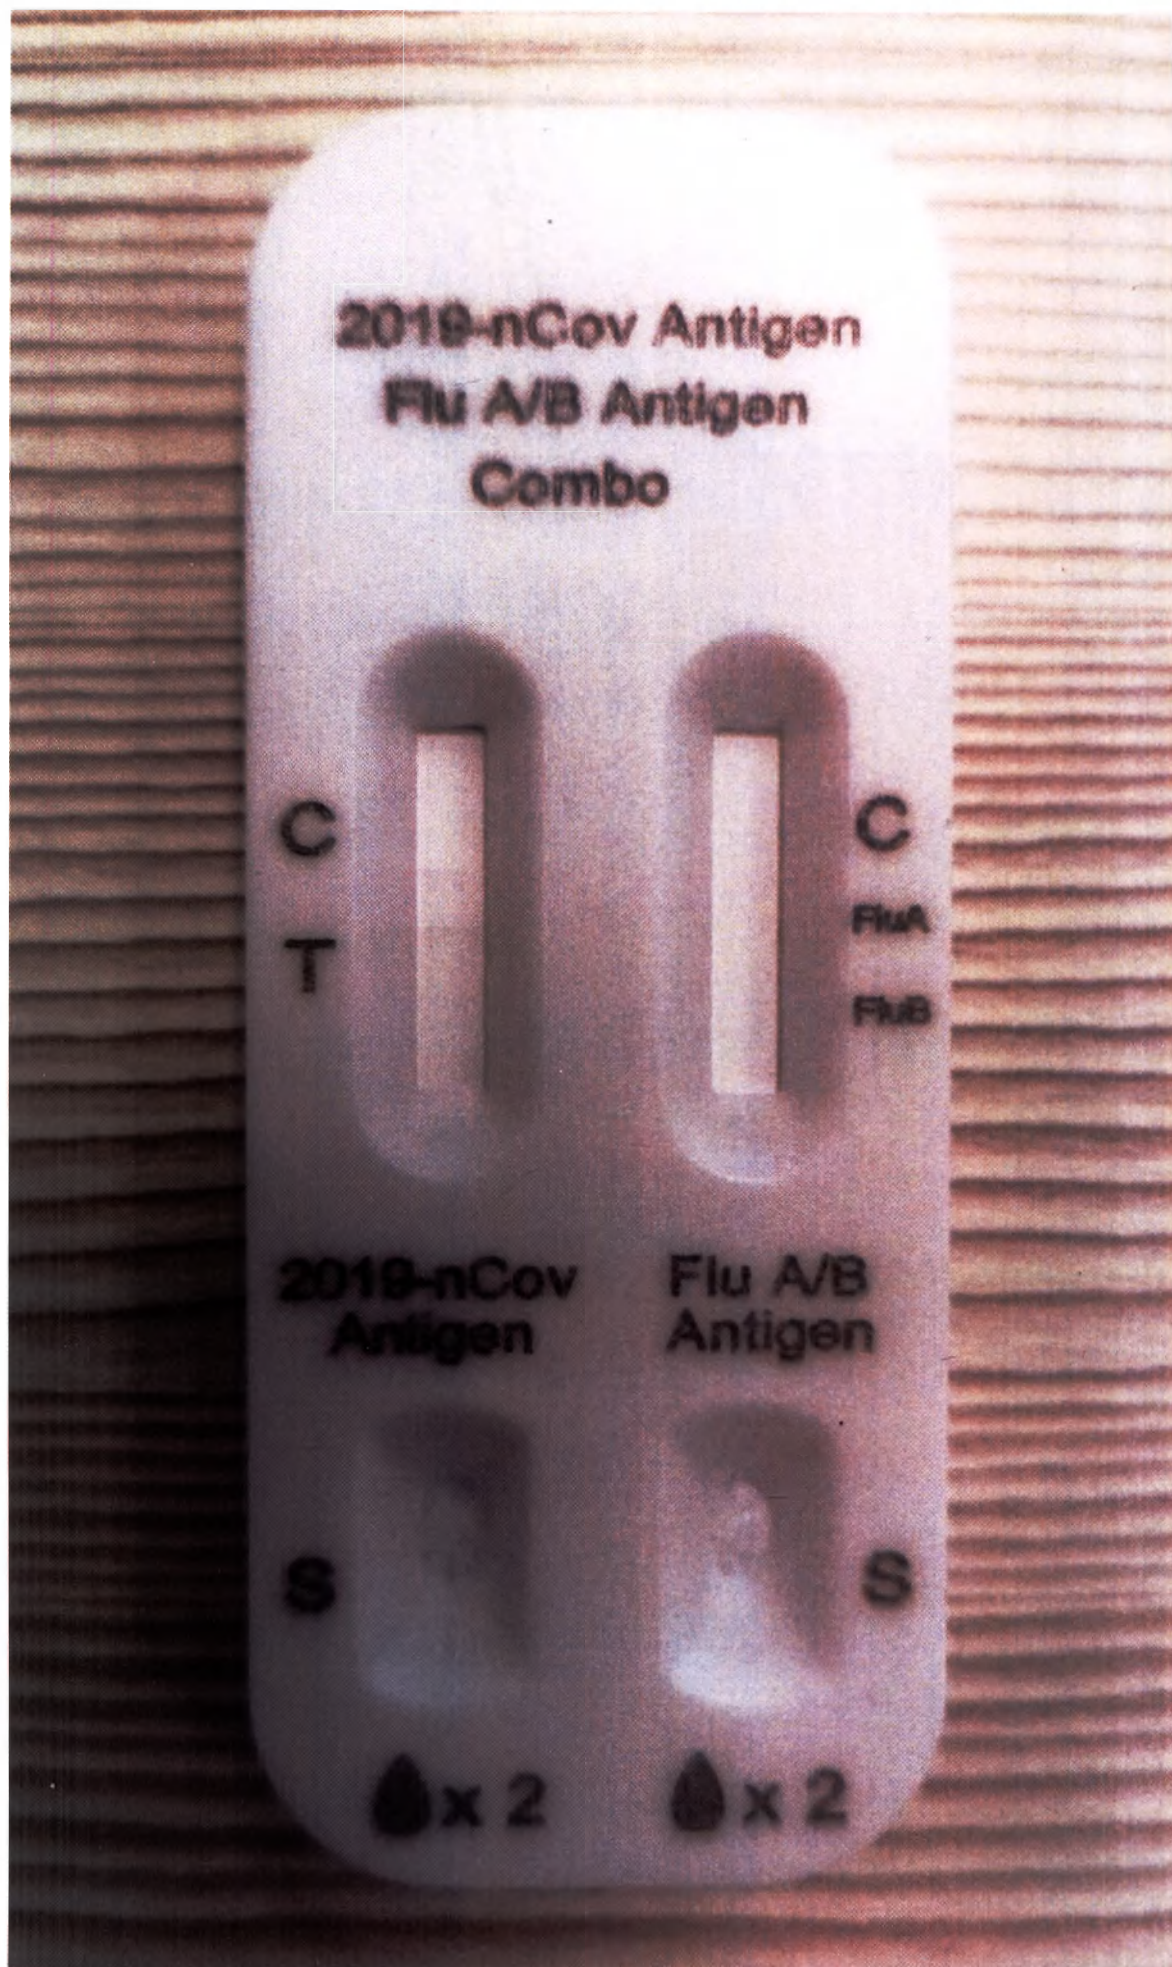

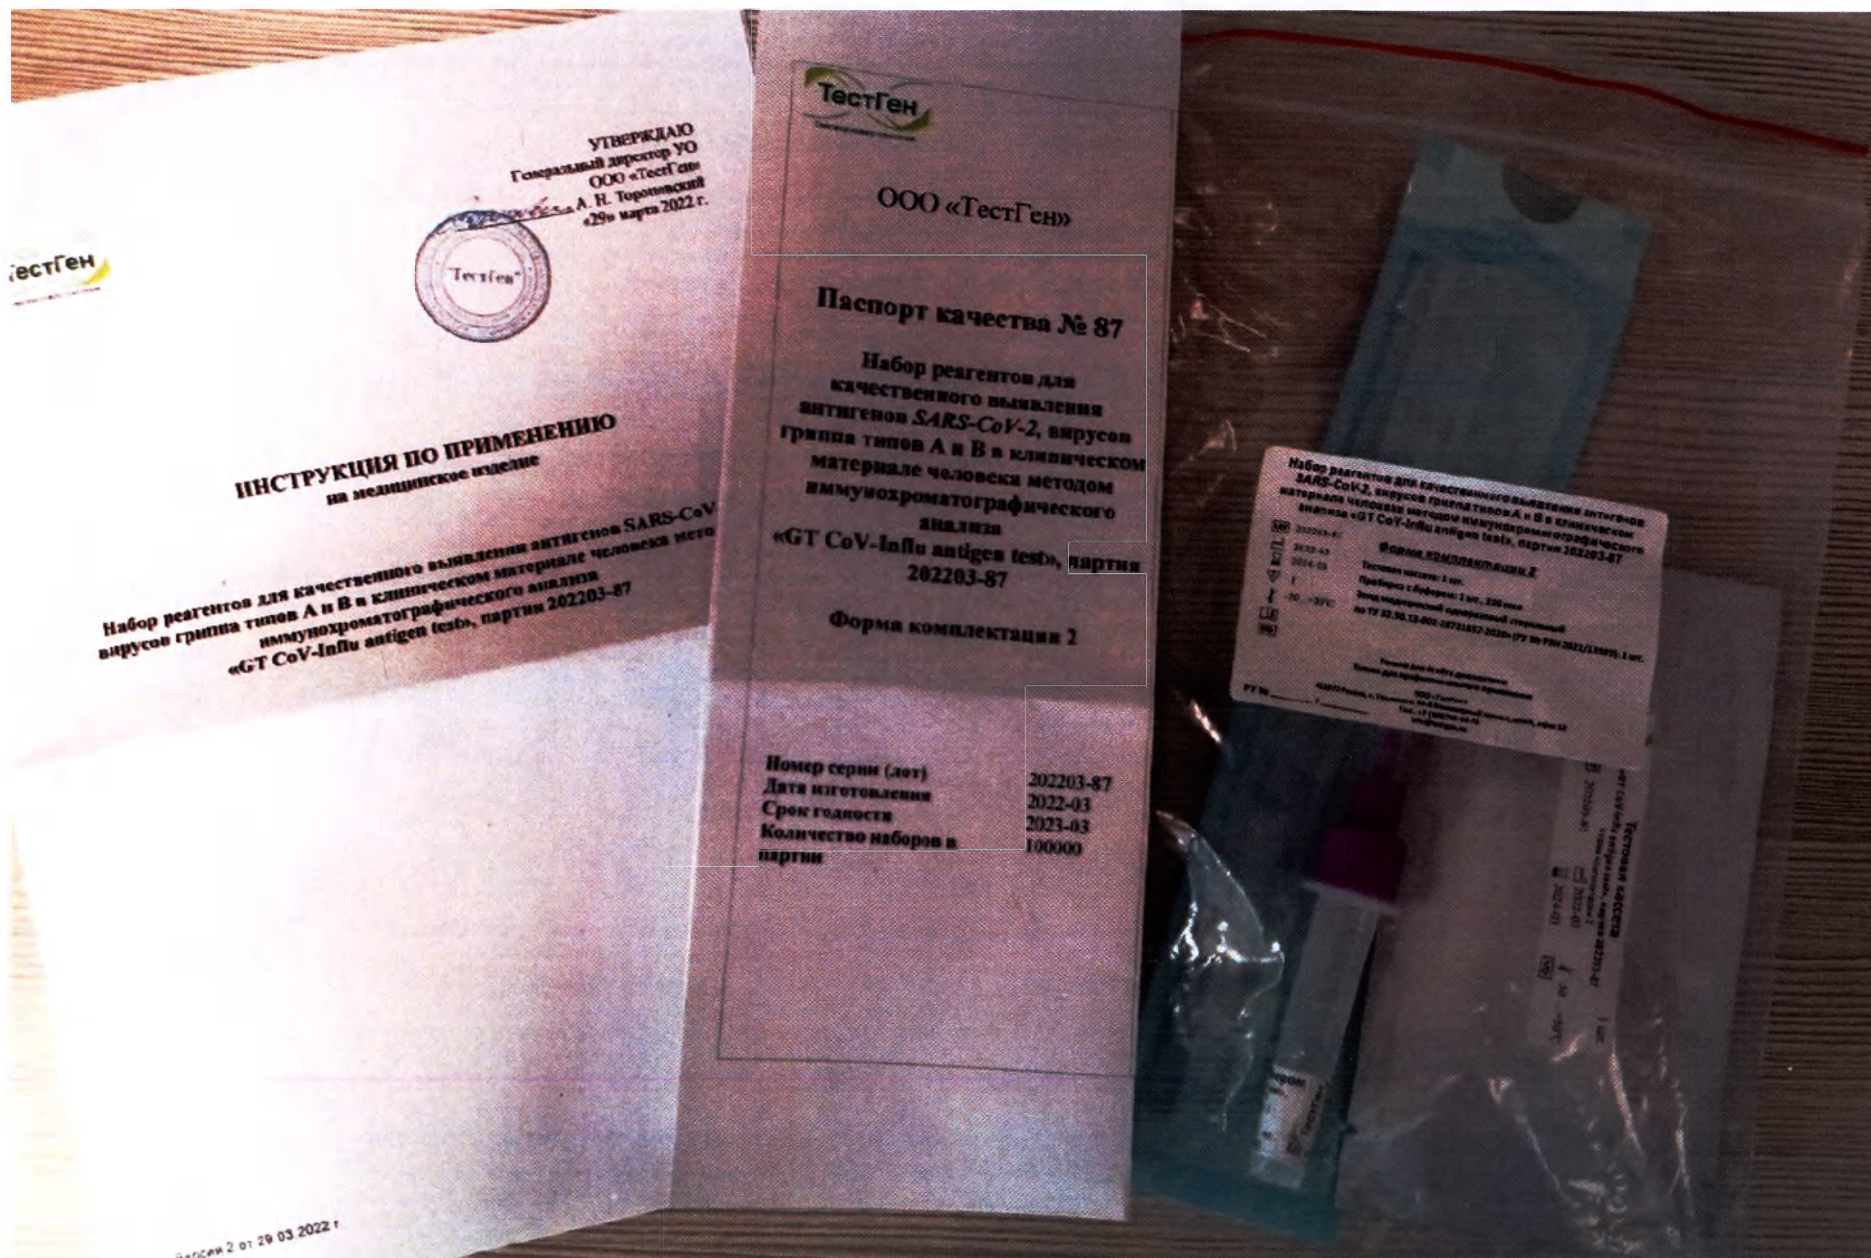

Издание 2 от 29.03.2022 г.

**Набор реагентов для качественного выявления антигенов
SARS-CoV-2, вирусов гриппа типов А и В в клиническом
материале человека методом иммунохроматографического
анализа «GT CoV-Influ antigen test», партия 202203-87**

LOT 202203-87

Форма комплектации 2

 2022-03

 2024-03

 1

 -30...+30°C





Тестовая кассета: 1 шт.

Пробирка с буфером: 1 шт., 330 мкл

Зонд медицинский одноразовый стерильный
по ТУ 32.50.13-002-28731857-2020» (РУ № РЗН 2021/13989): 1 шт.

Только для in vitro диагностики
Только для профессионального применения

ООО «ТестГен»

432072 Россия, г. Ульяновск, 64-й Инженерный проезд, дом 6, офис 13

Тел.: +7 (899) 705-03-75


info@testgen.ru


1 шт.

202203-87

-30

IVD

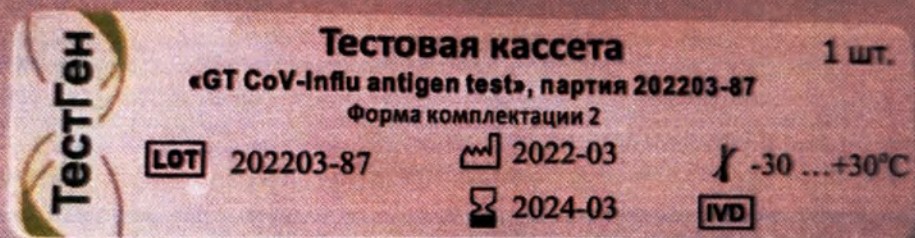

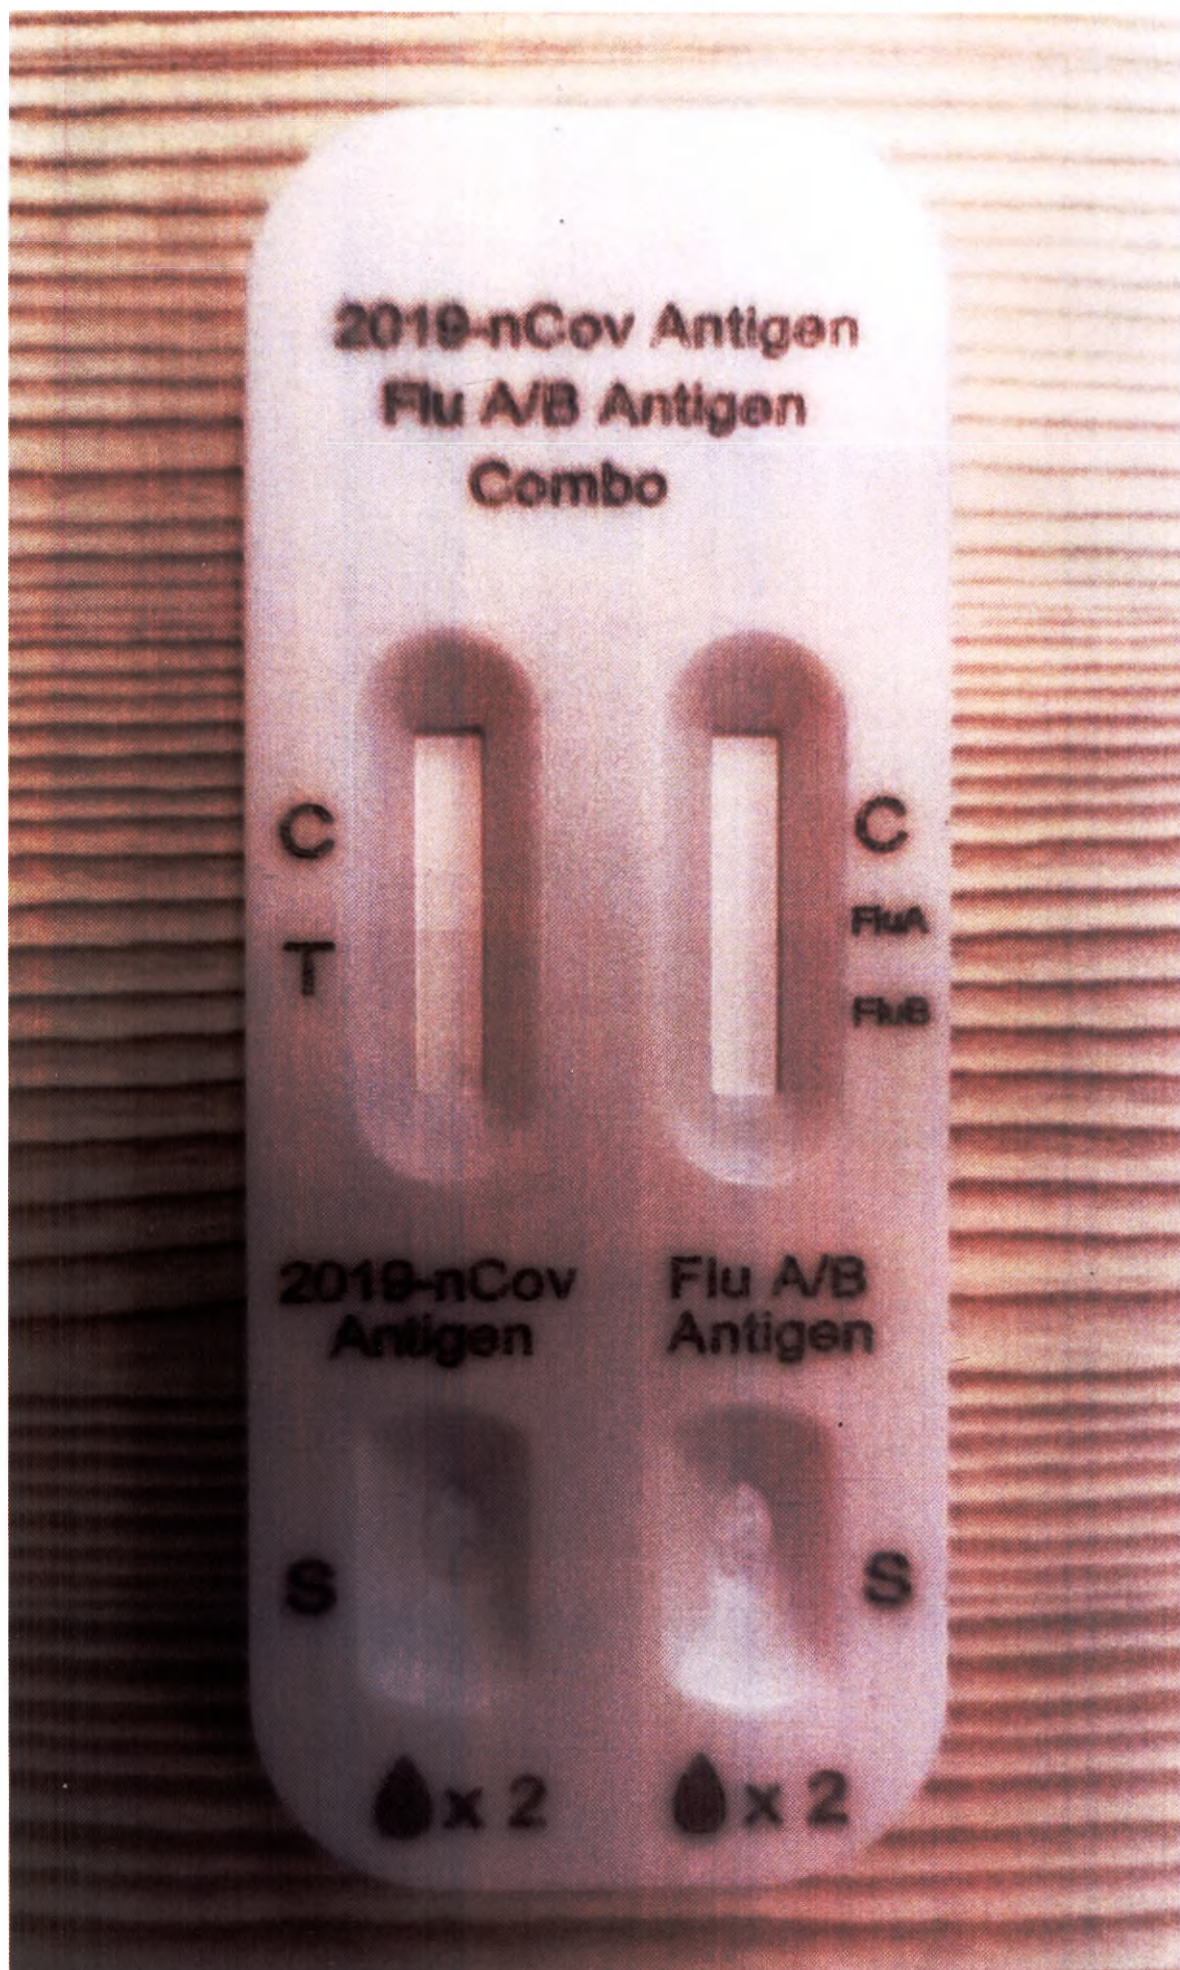

Одноразовый стерильный
зонд медицинский

Производитель:
ООО «ФАРММЕДПОЛИС РТ»
420017, Республика Татарстан,
Лаишевский район, село Большие
Кабаны, Выставочная улица, 1,
Кластер «В».

Лот: 02/2021
Дата изготовления: 04/2021
Срок годности: 04/2026



ФармМедПолис®

Зонд медицинский одноразовый стерильный


Производитель:
ООО «ФАРММЕДПОЛИС РТ»
420017, Республика Татарстан,
Лаишевский район, село Большие
Кабаны, Выставочная улица, 1,
Кластер «В».

Номер и дата регистрационного
удостоверения:
РЗН 2021/13989 от 12.04.2021

LOT 02/2021

04/2021

04/2026



ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЗАПЕЧАТАННО

ТУ 32.50.13-002-28731857-2020

STERILE EO

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПО ИСТЕЧЕНИИ СРОКА ГОДНОСТИ • УТИЛИЗИРОВАТЬ ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ • DO NOT USE AFTER EXPIRATION DATE • DISPOSE OF AFTER USE



Пролито, пронумеровано и
скреплено печатью

12 (двенадцать) листов

Должность: ген. директор

Тороповский А.Н.

