




Фотографические изображения медицинского изделия:
Лазер эксимерный MEL 80

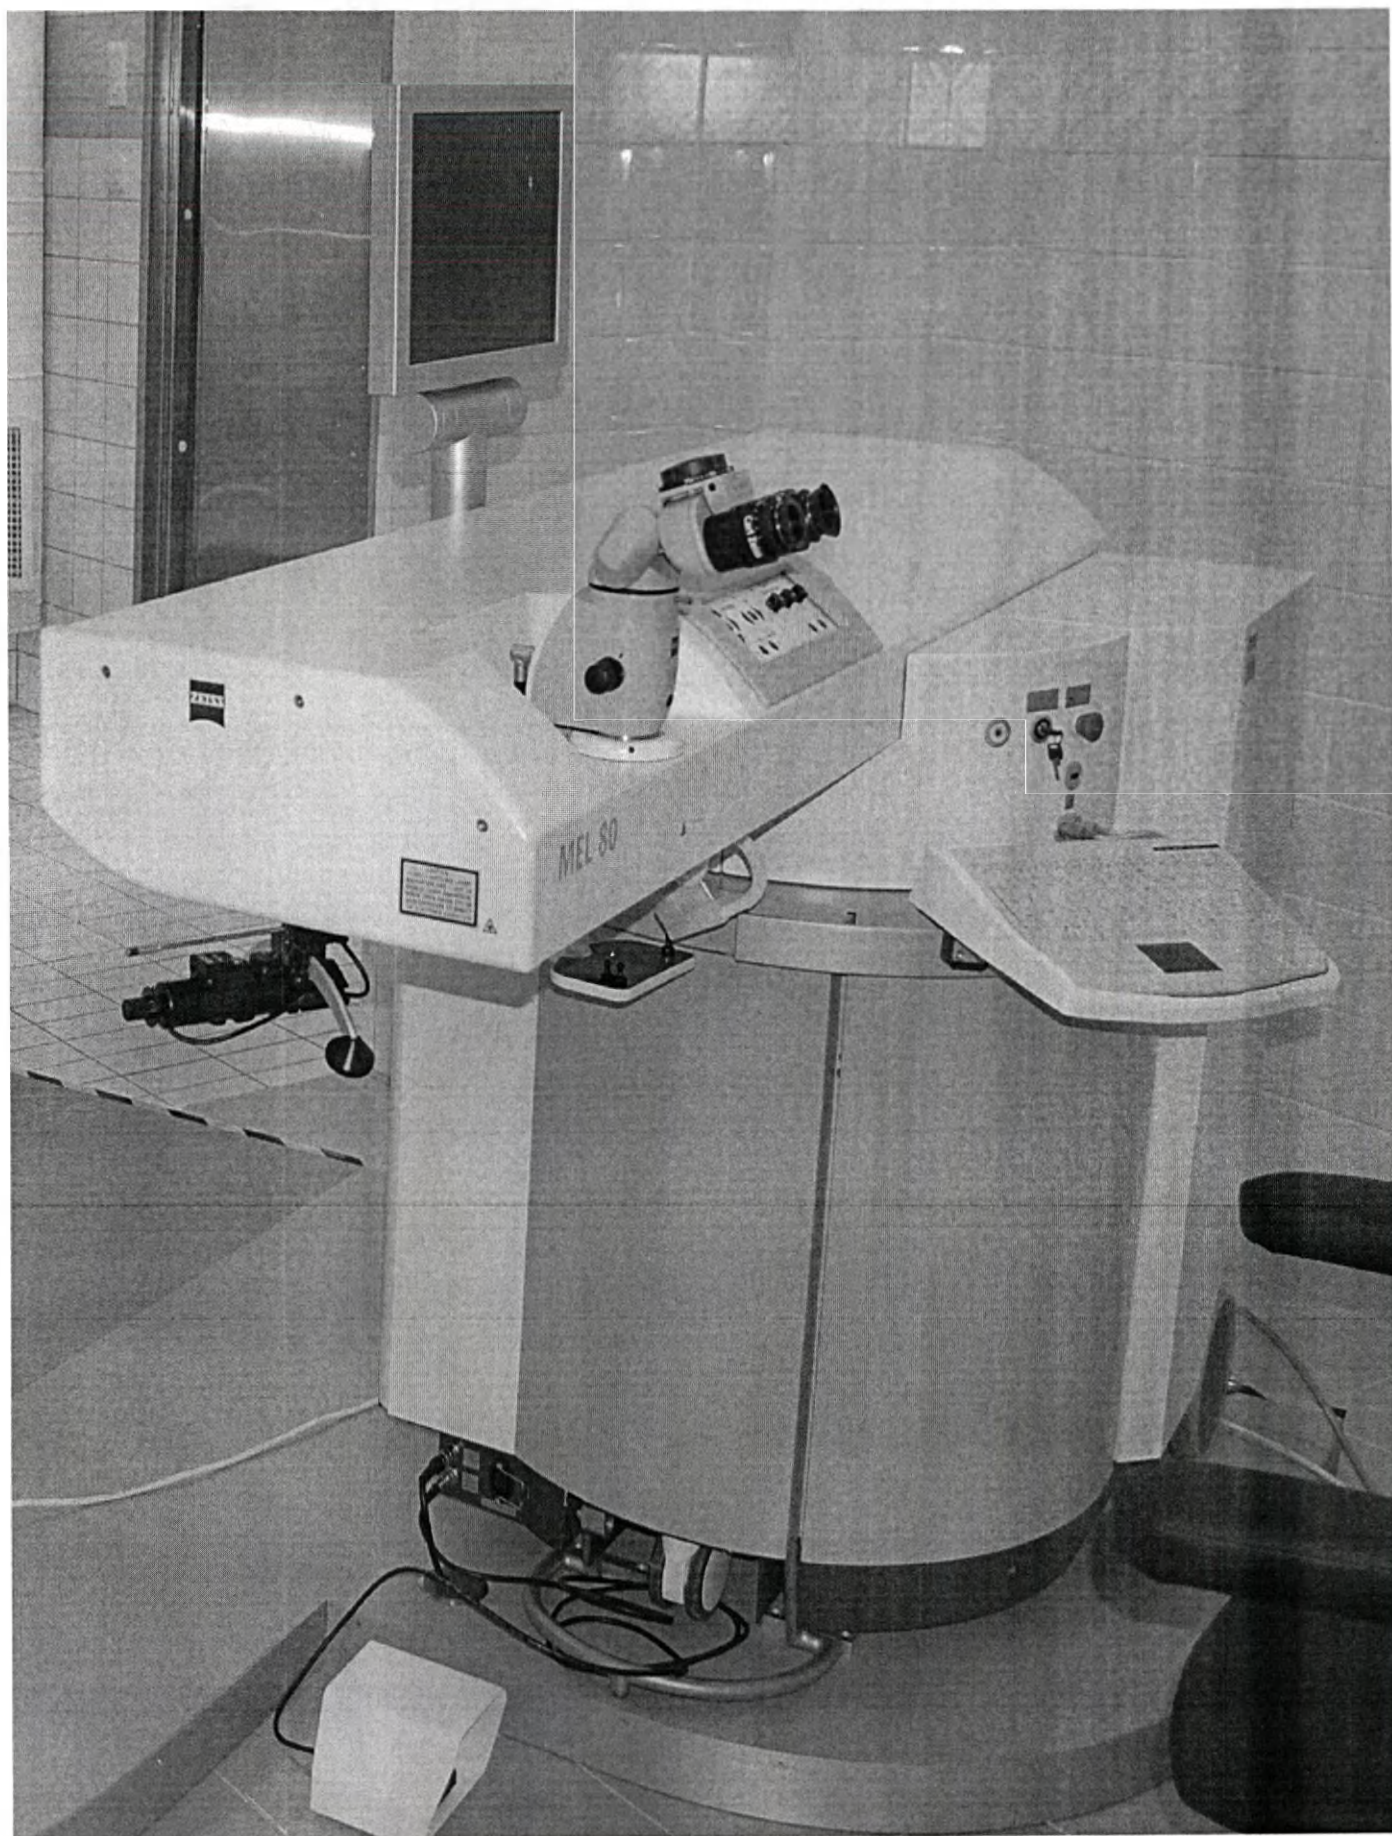


Лазер эксимерный MEL 90

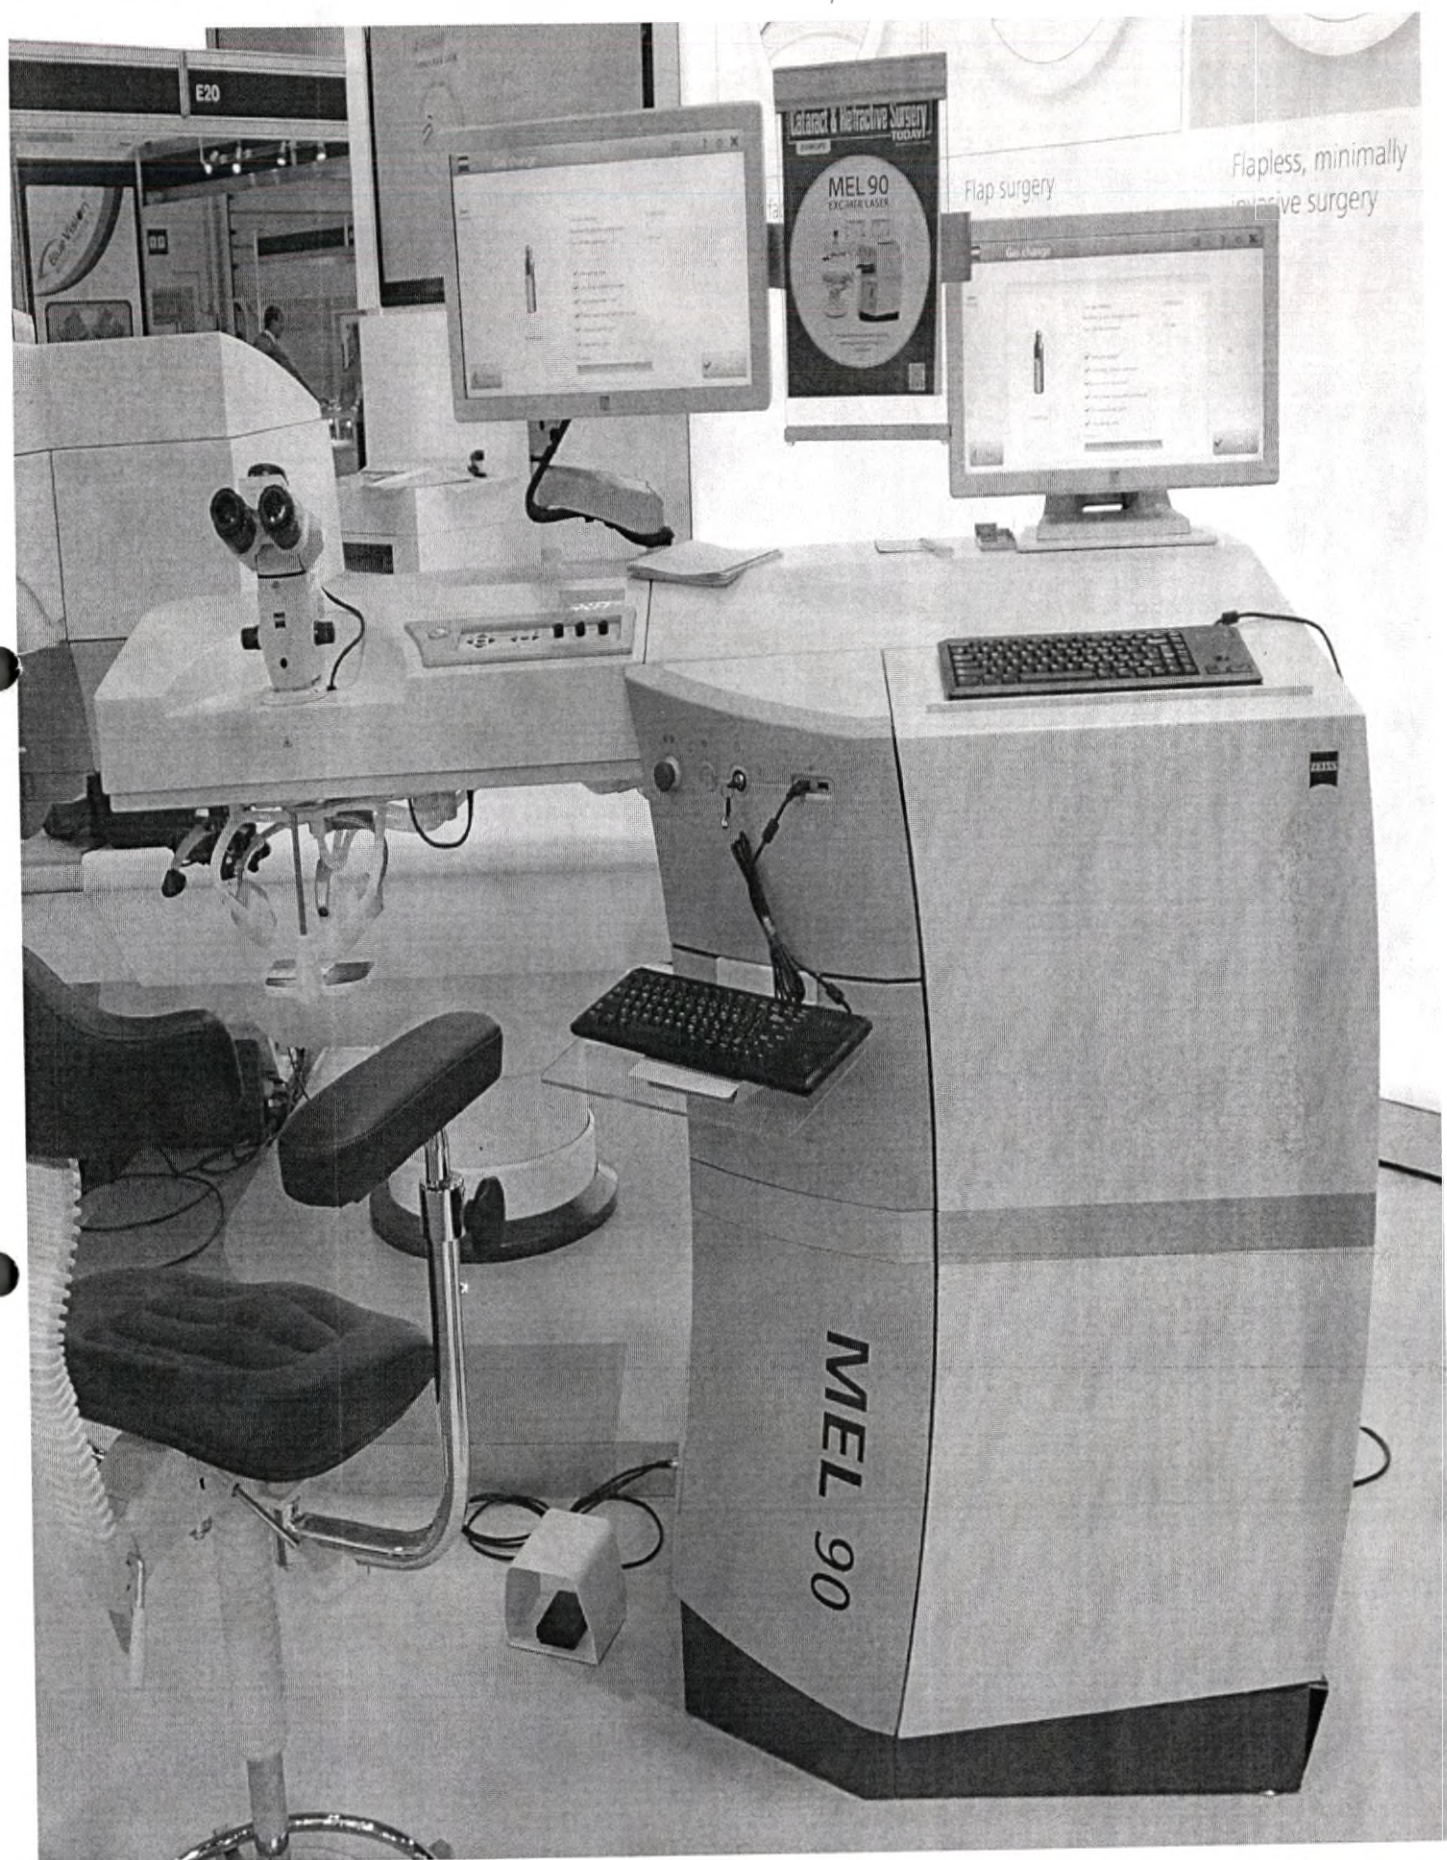


Кресло для врача (не более 2 шт.).

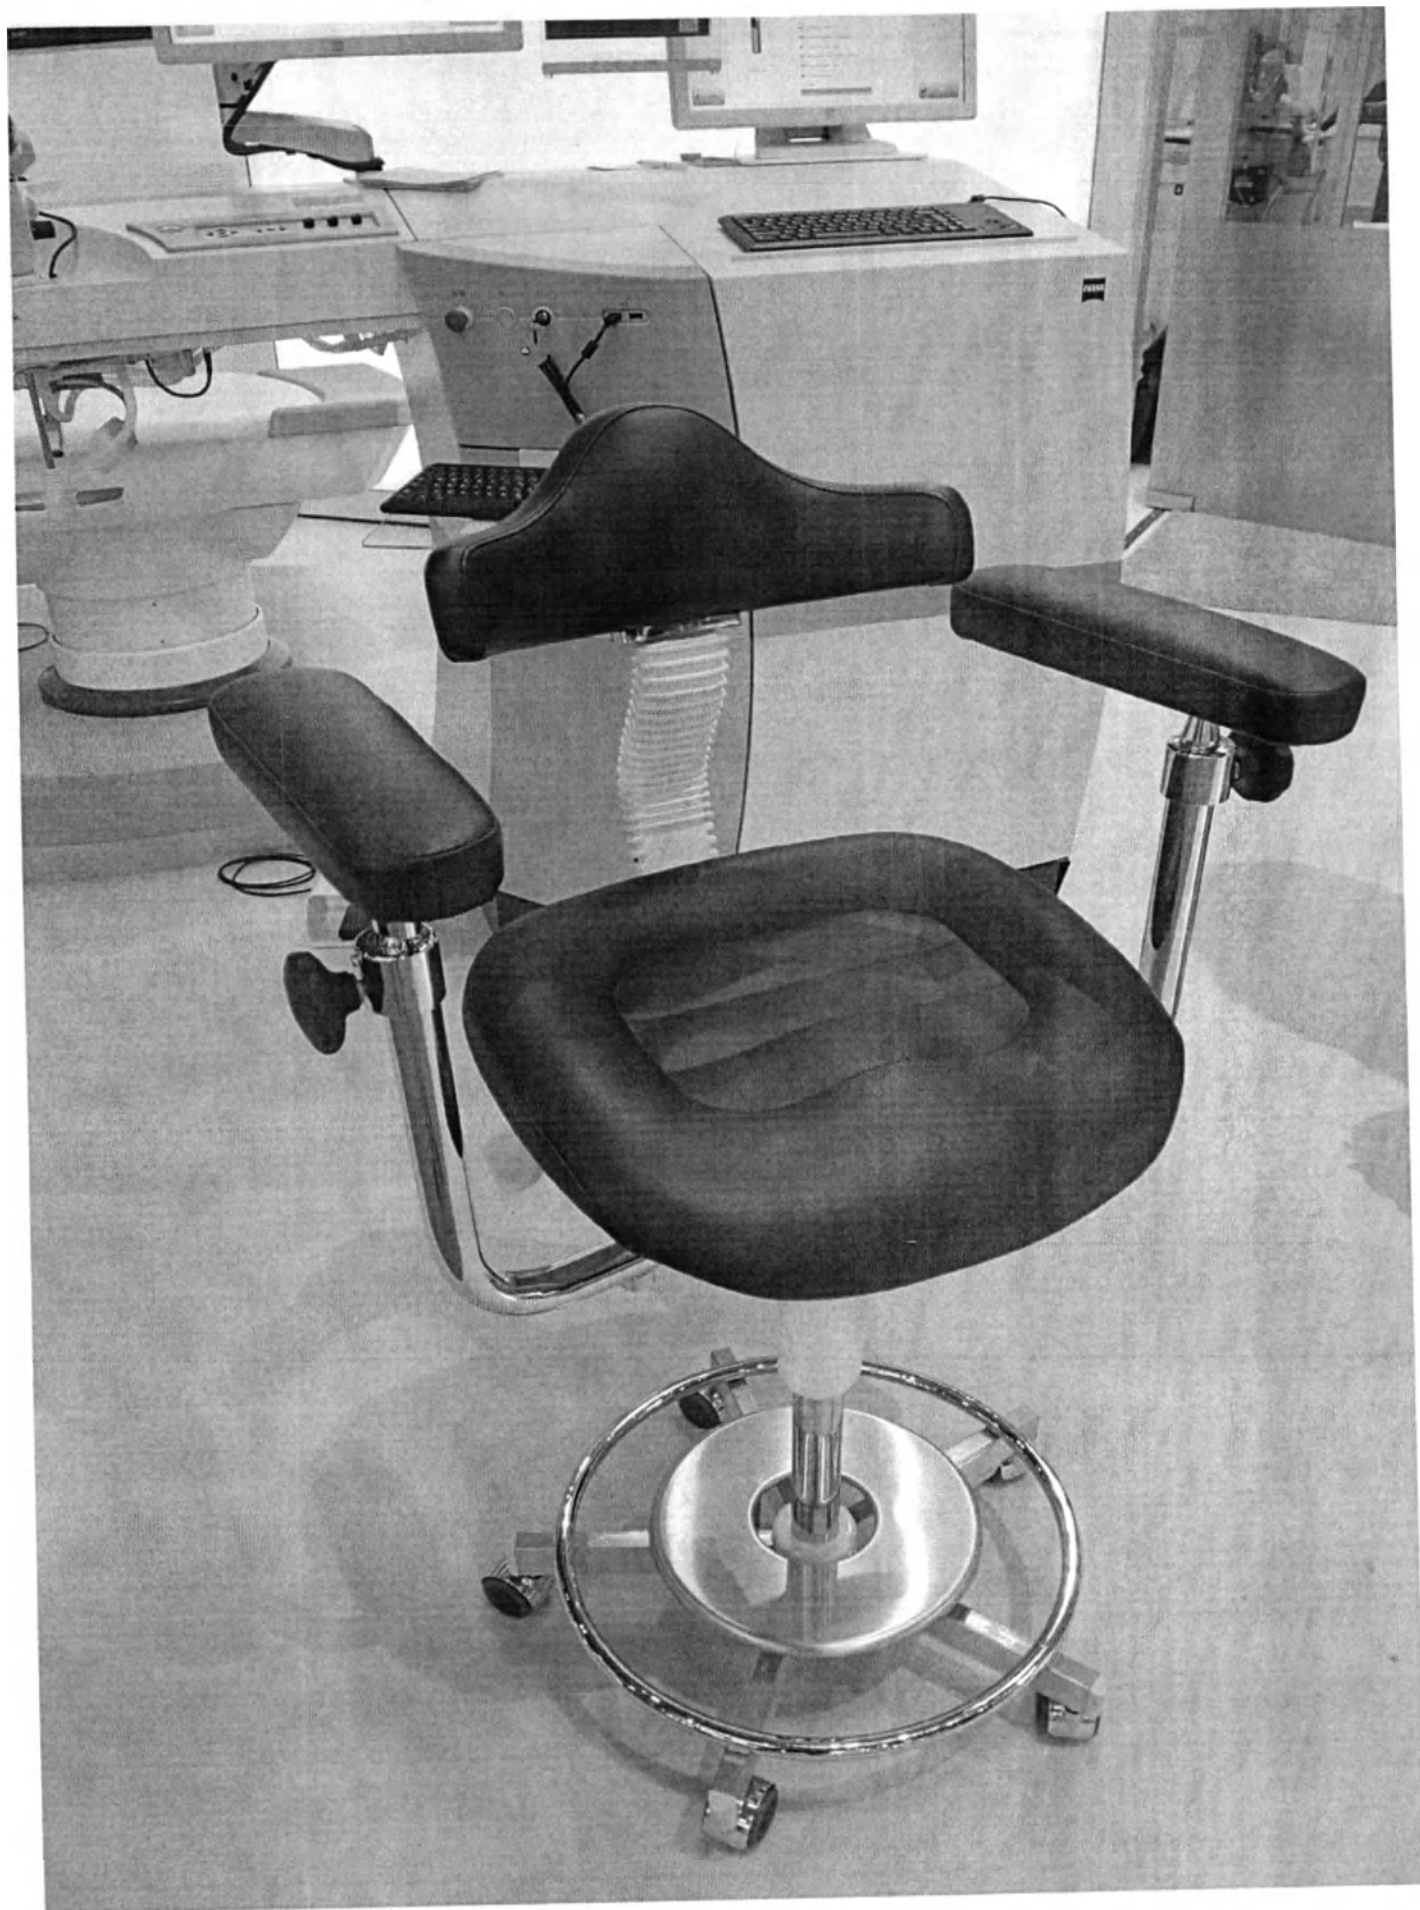

Стол операционный LS Comfort 80.

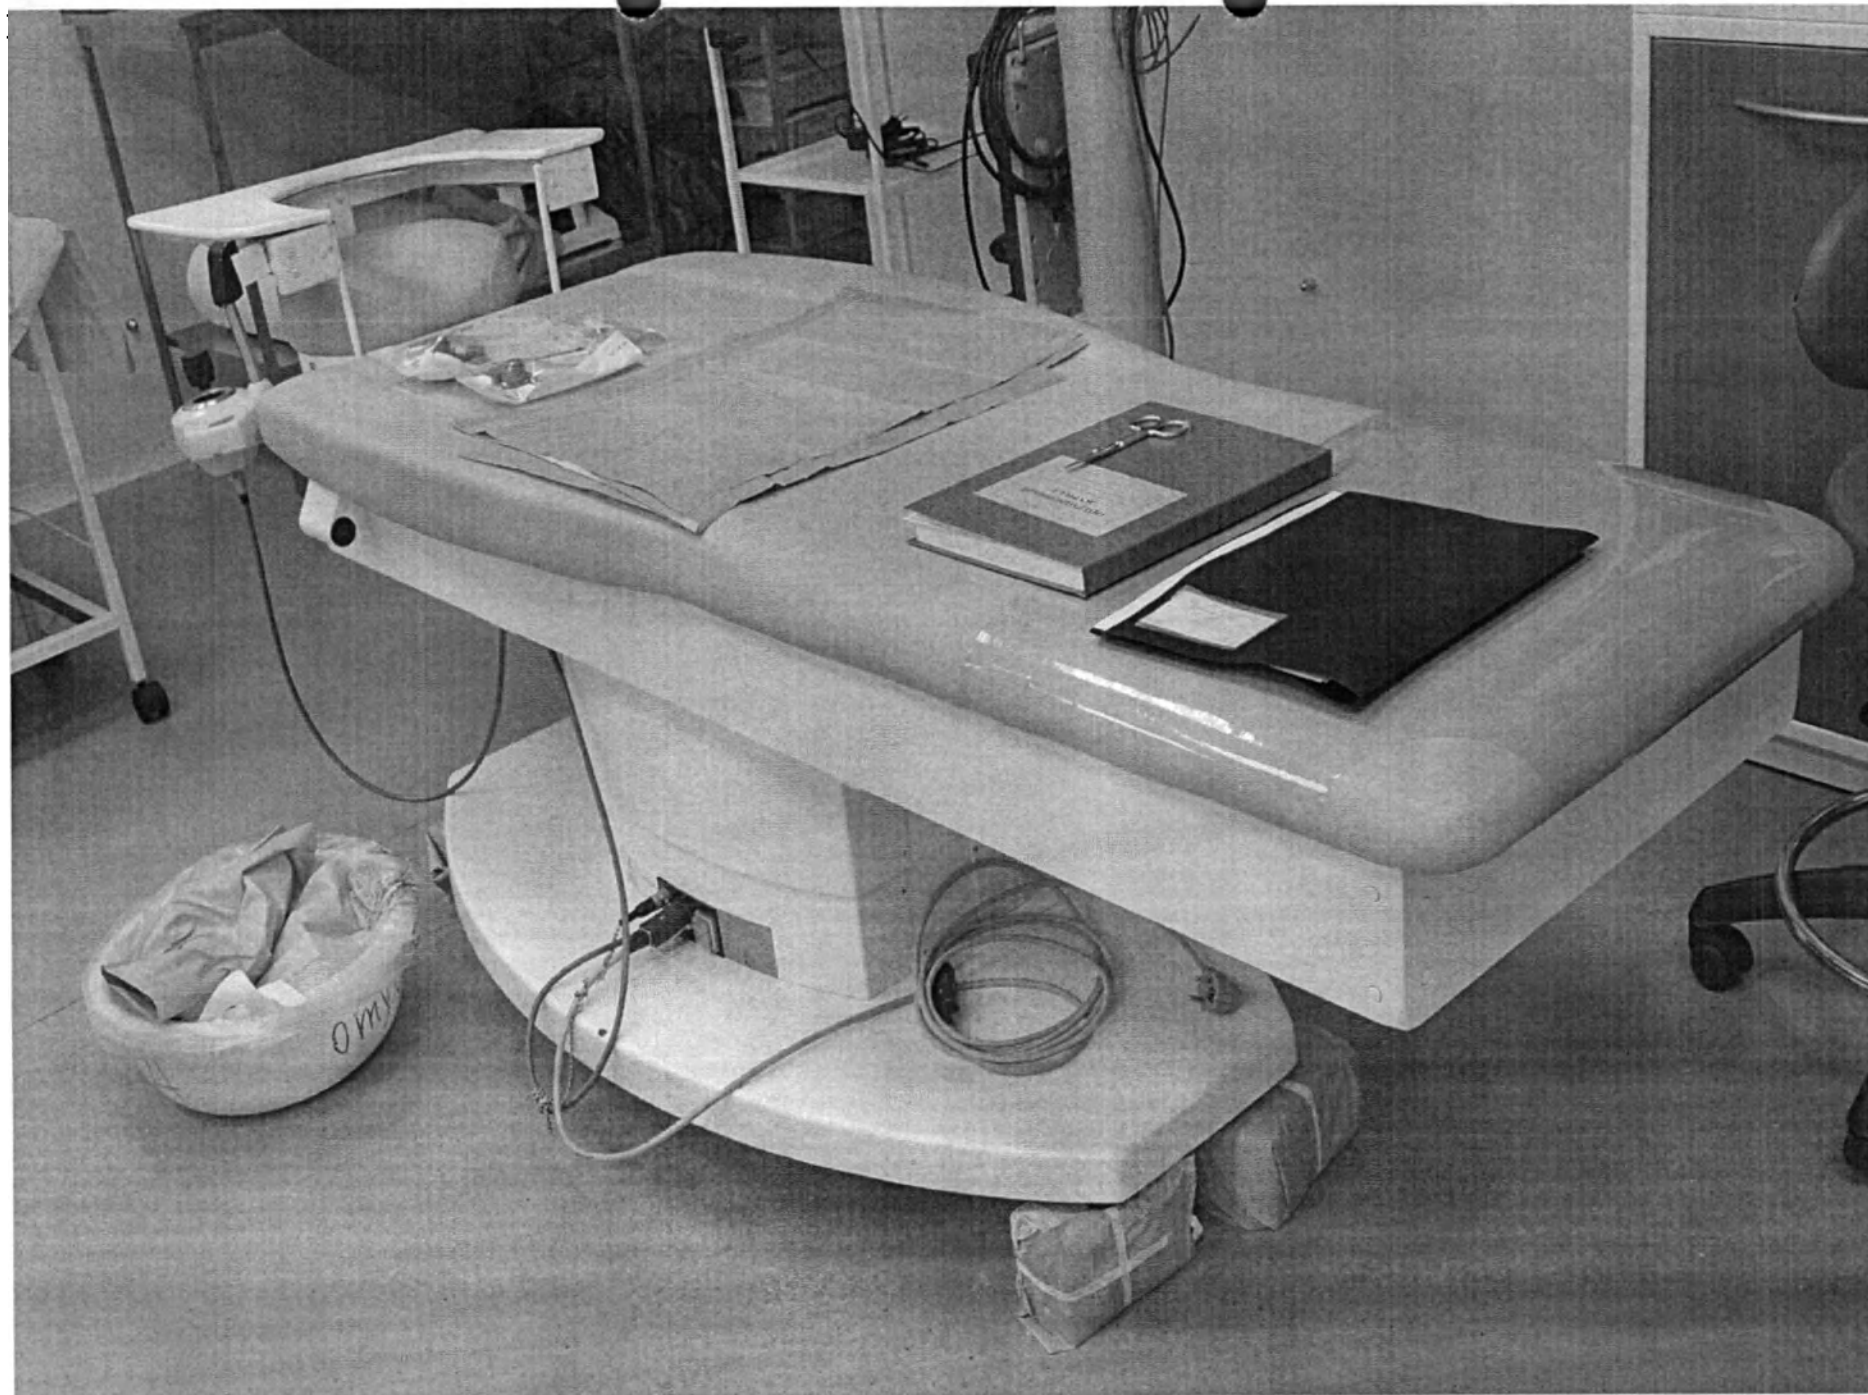

Устройство для анализа оптической aberrации глаза.

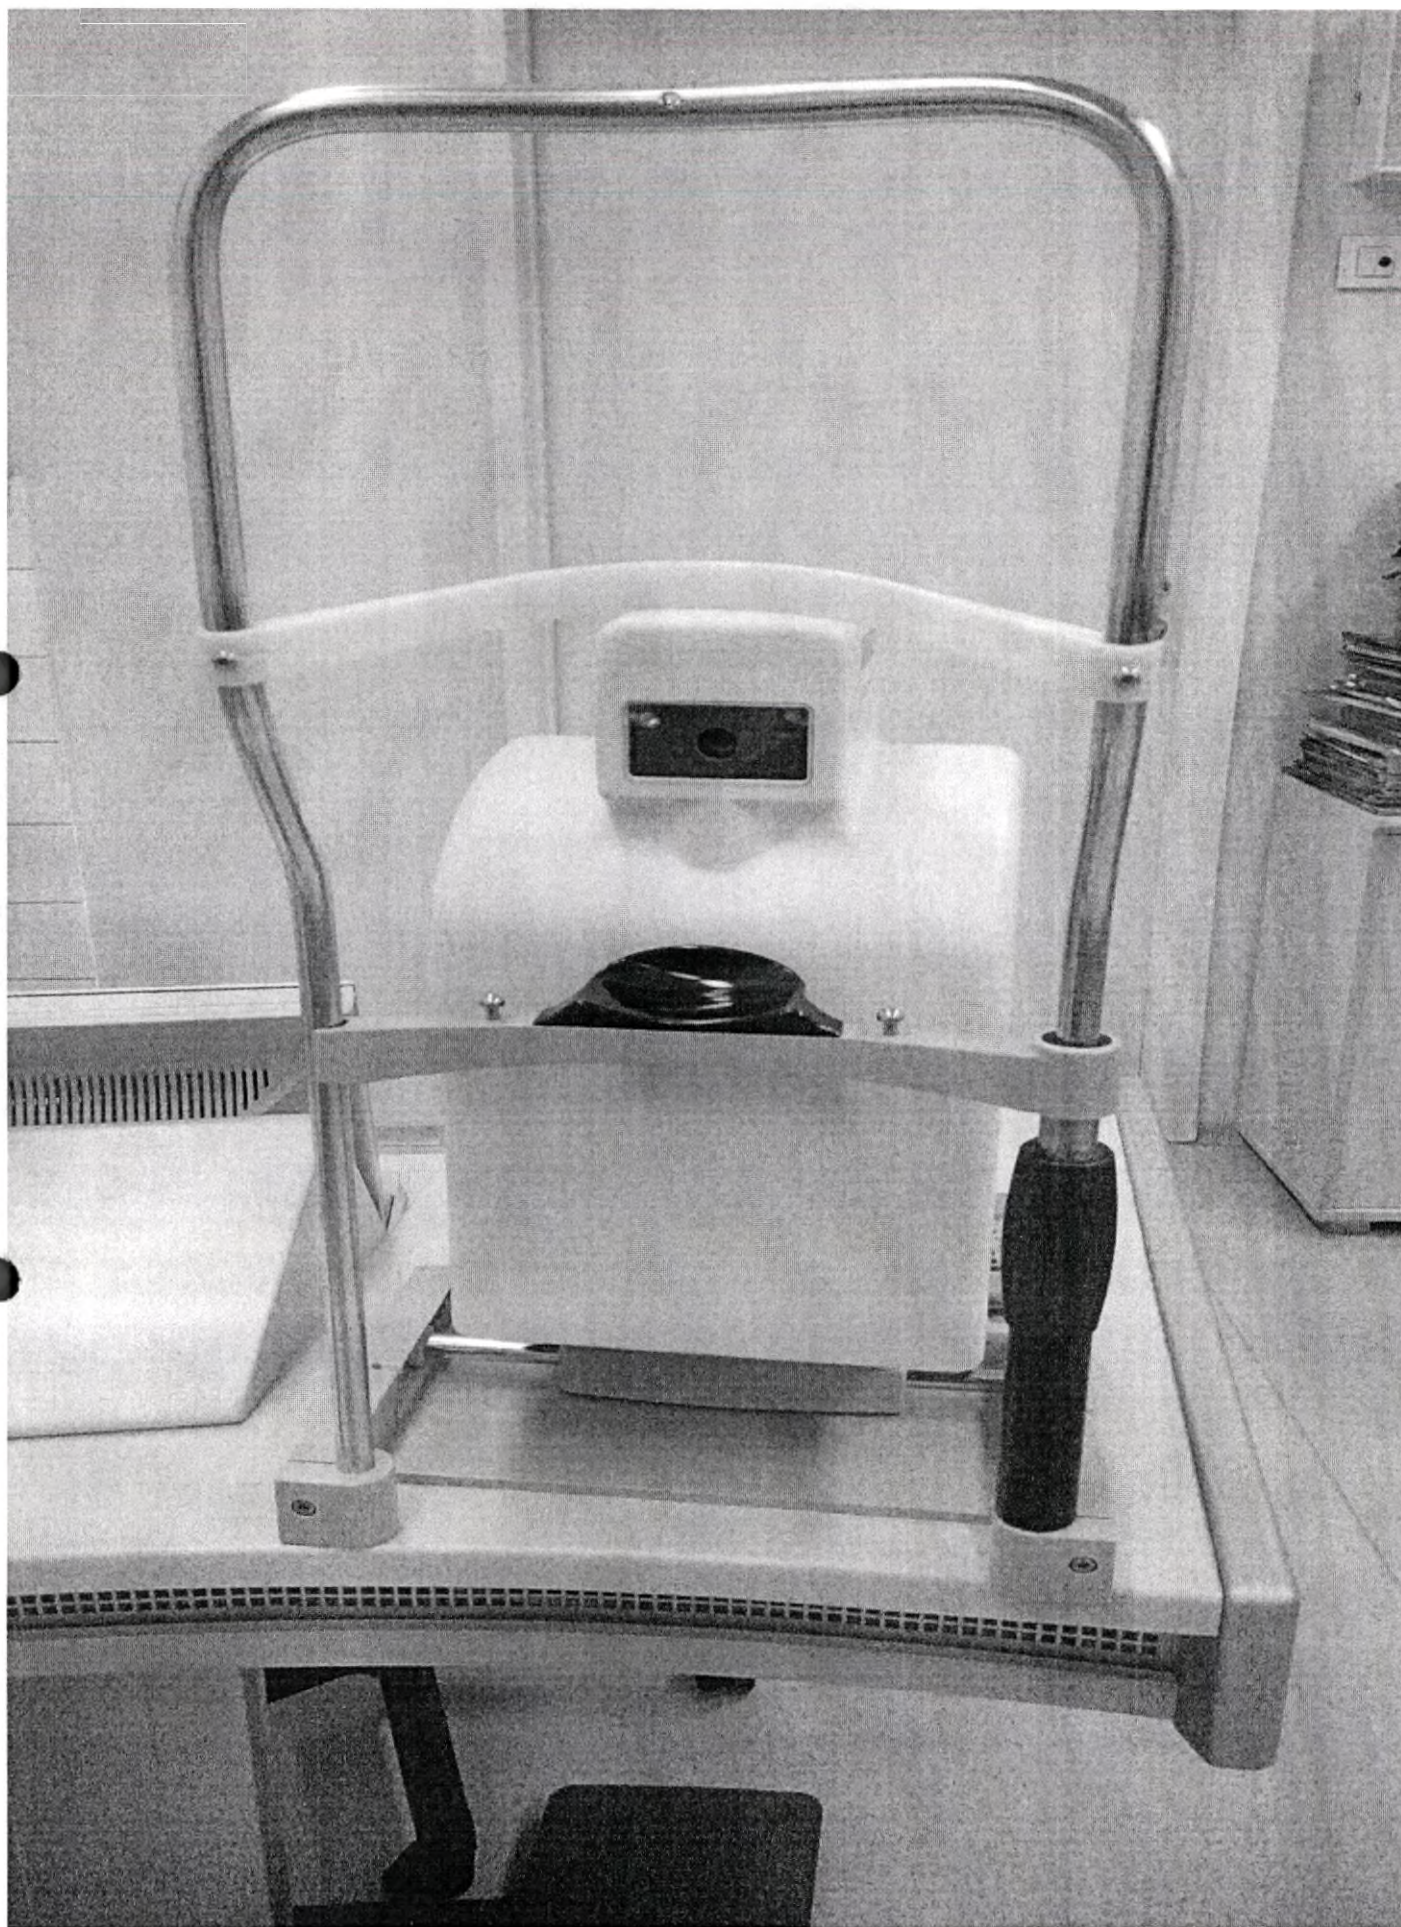

II. Принадлежности Интерфейсный комплект для Vi Max (не более 2 уп.).



Certificate Number: **146862310482**

License Certificate

Carl Zeiss Meditec AG grants the right to activate the following product:


Treatment License	Product	VisuMax Serial No.	Part Number
DEFB-11C6-A913-B387	Treatment Licence Flap50	1021447	1486-314

Please keep this sheet for future reference.




PIN 000000-1483-220


Корнеотопограф Atlas.

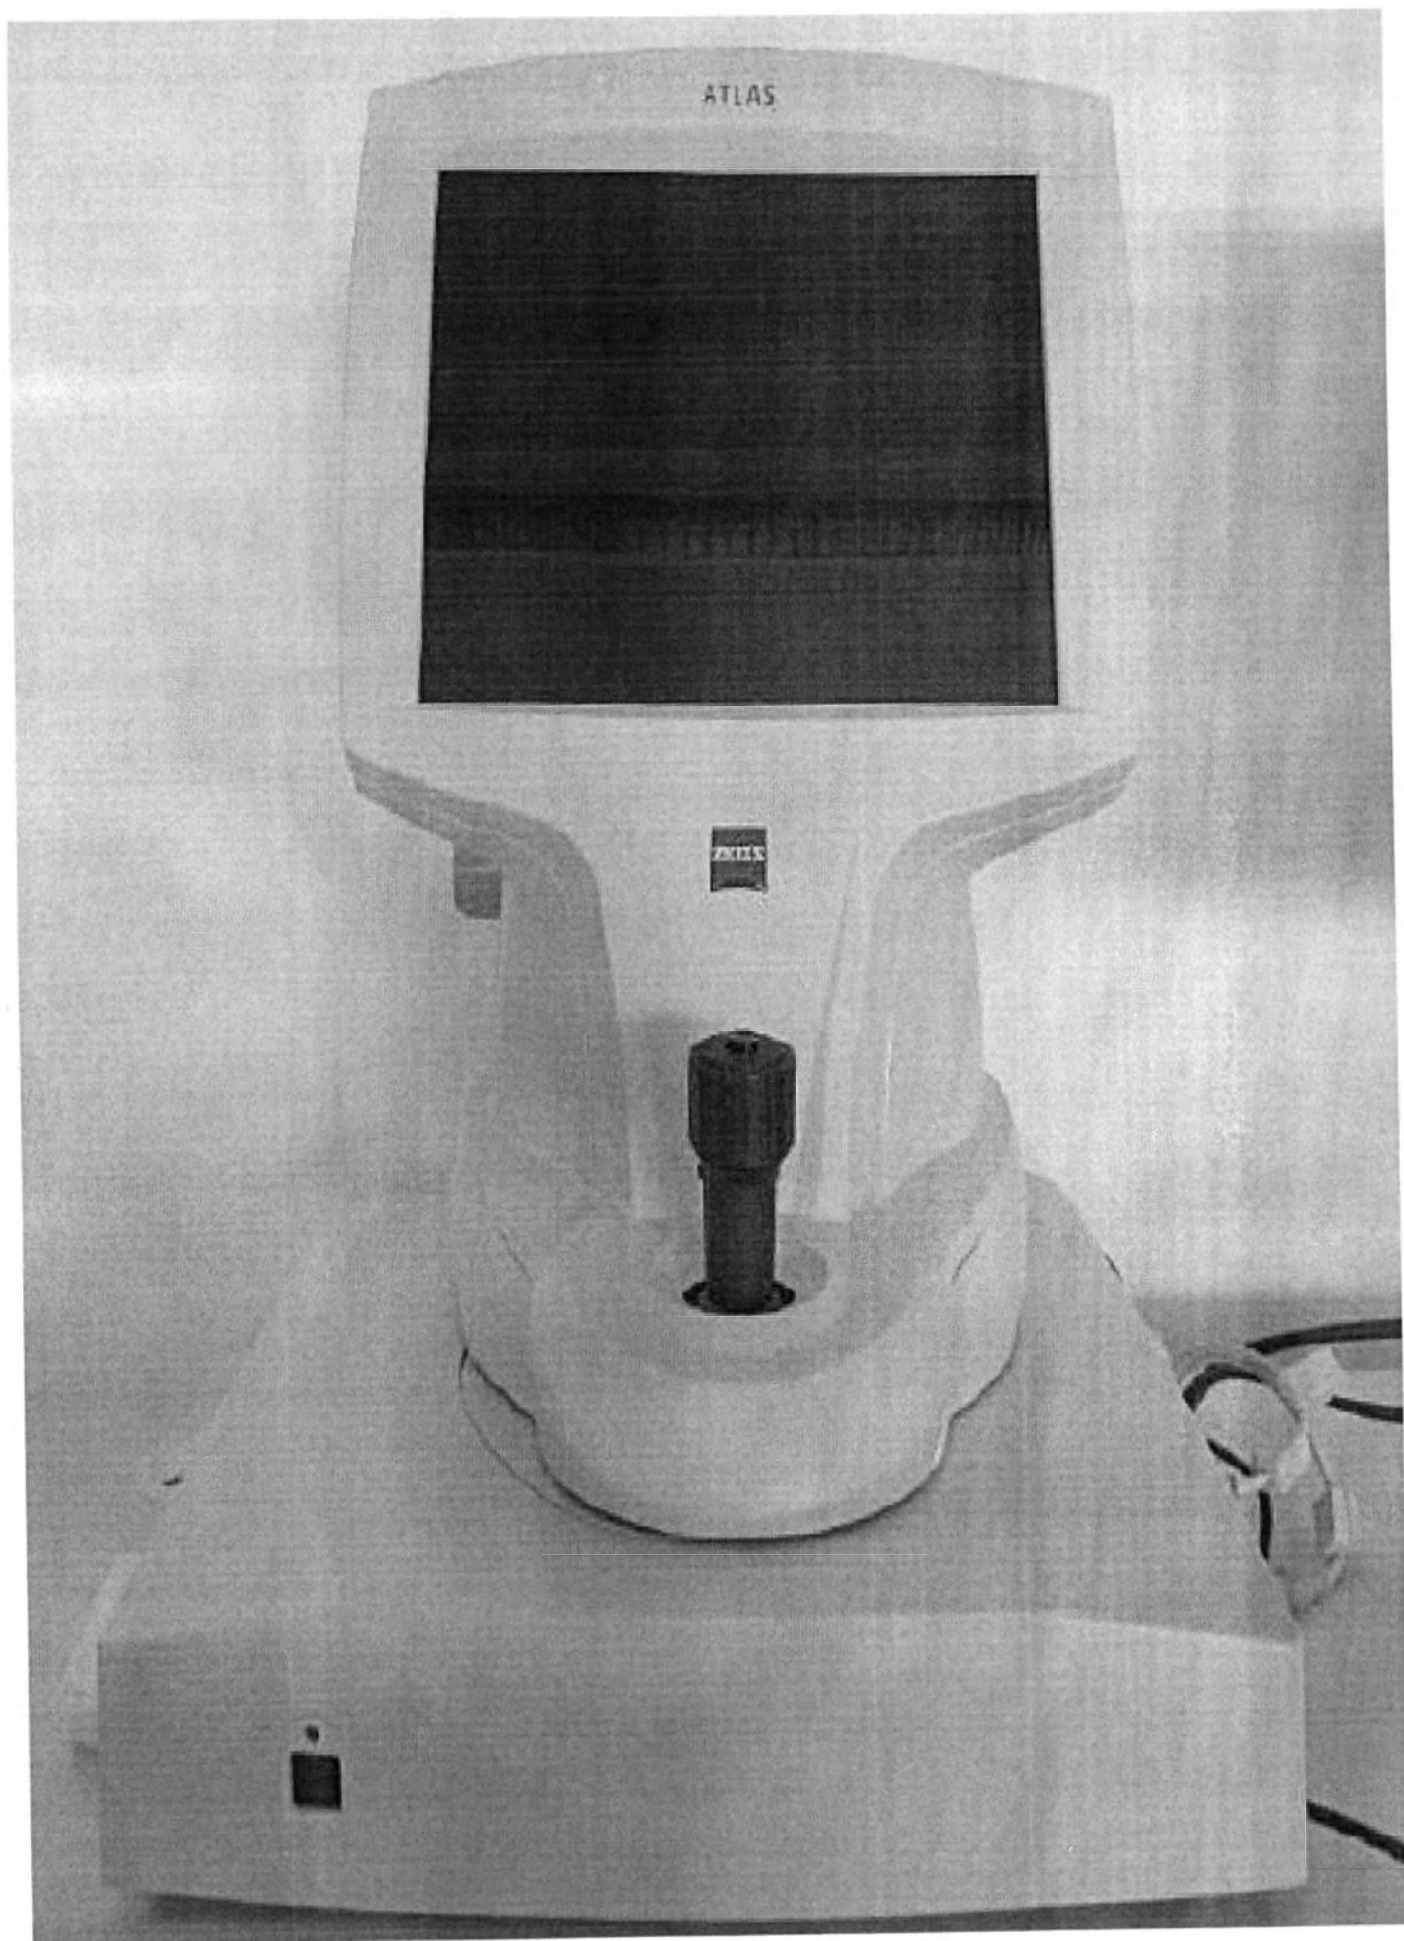


Цилиндр газовый (не более 2 шт.) Держатель для цилиндра газового.

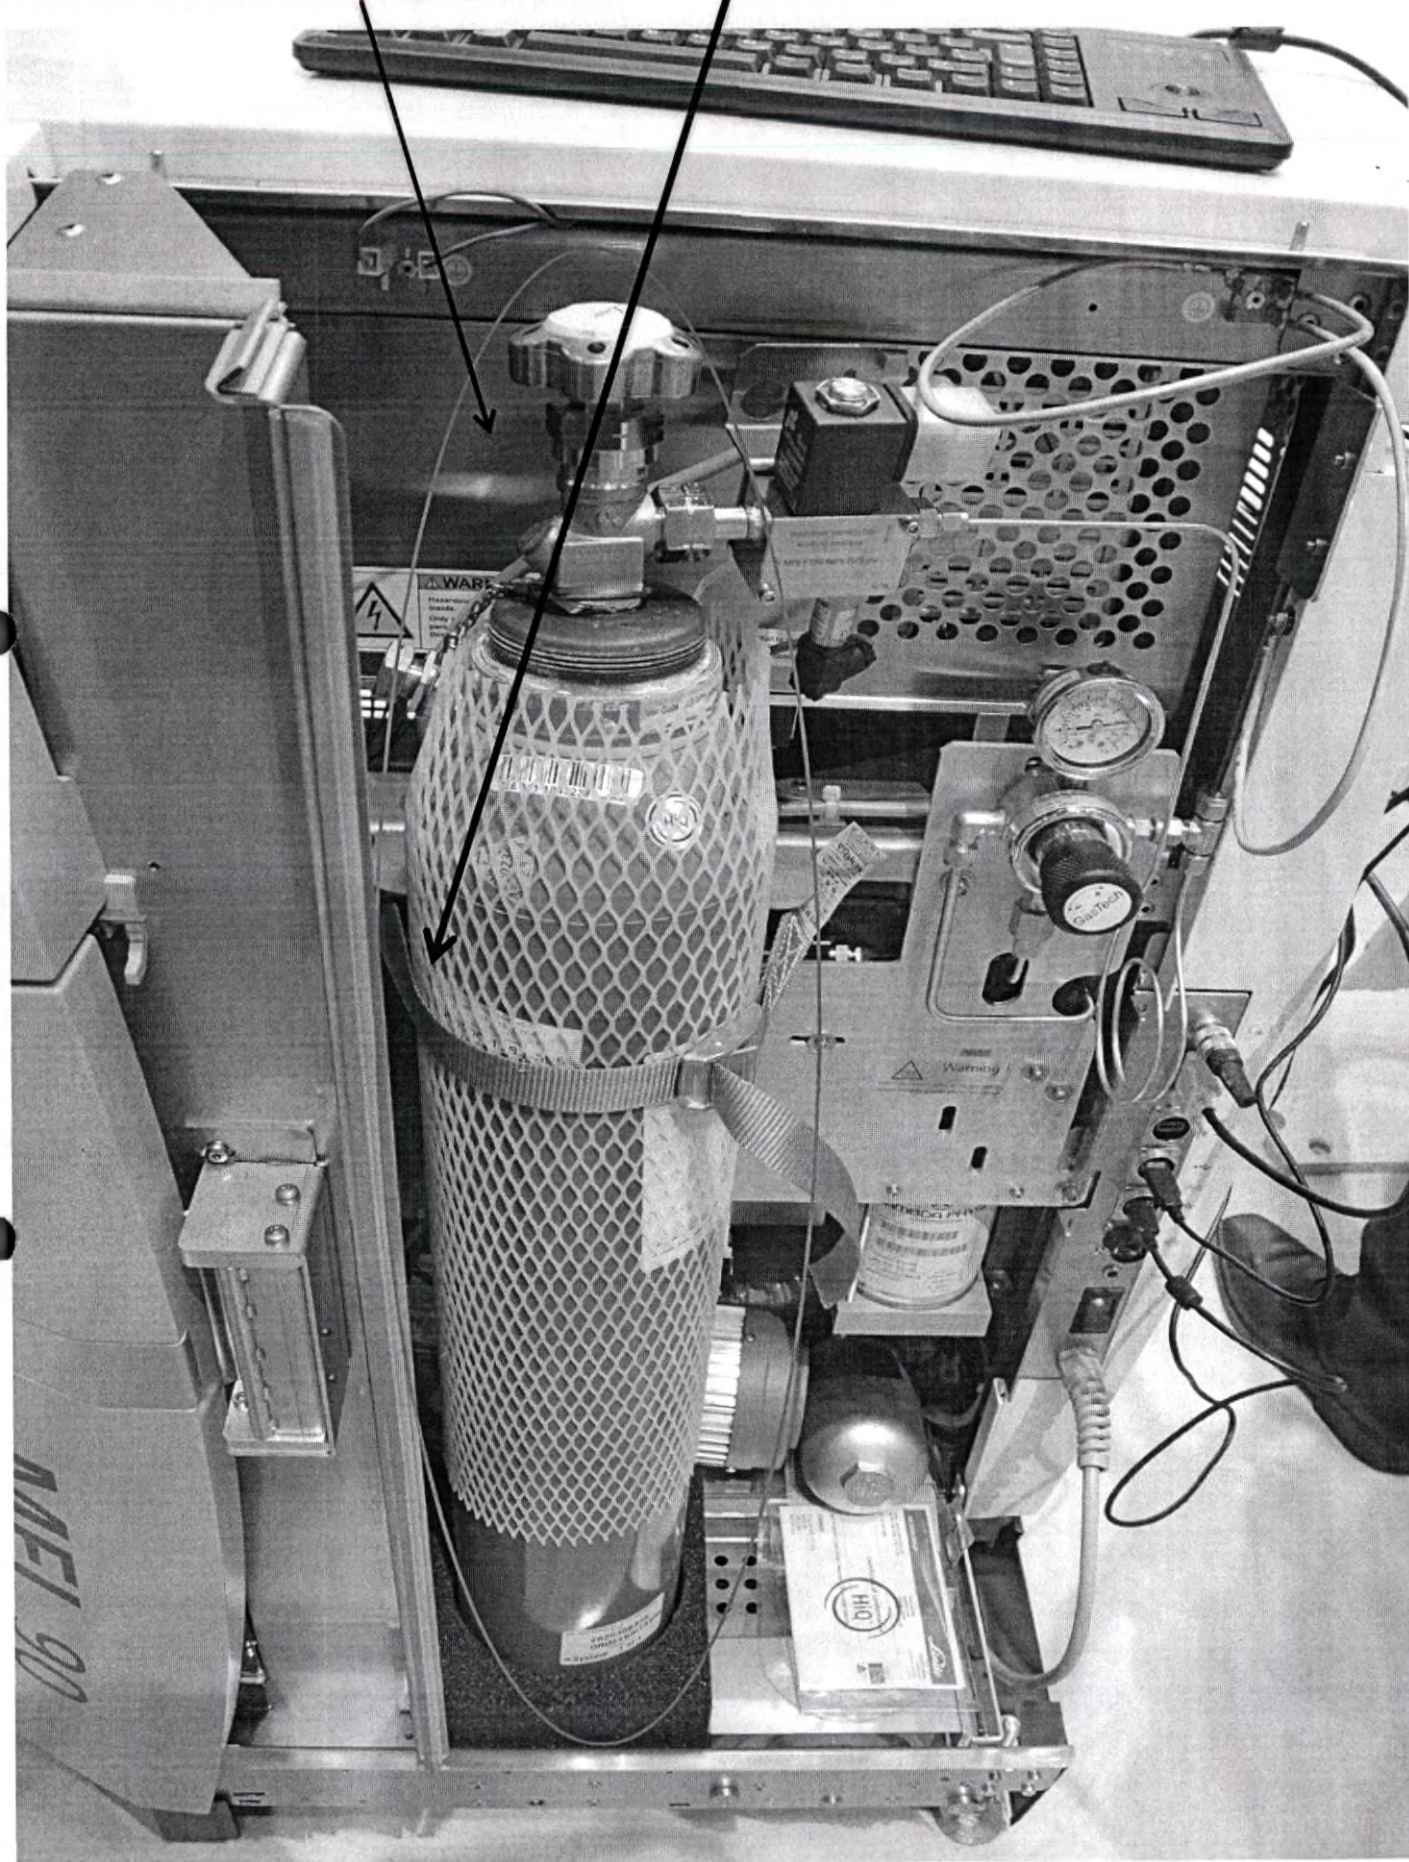


Лампа щелевая ручная.

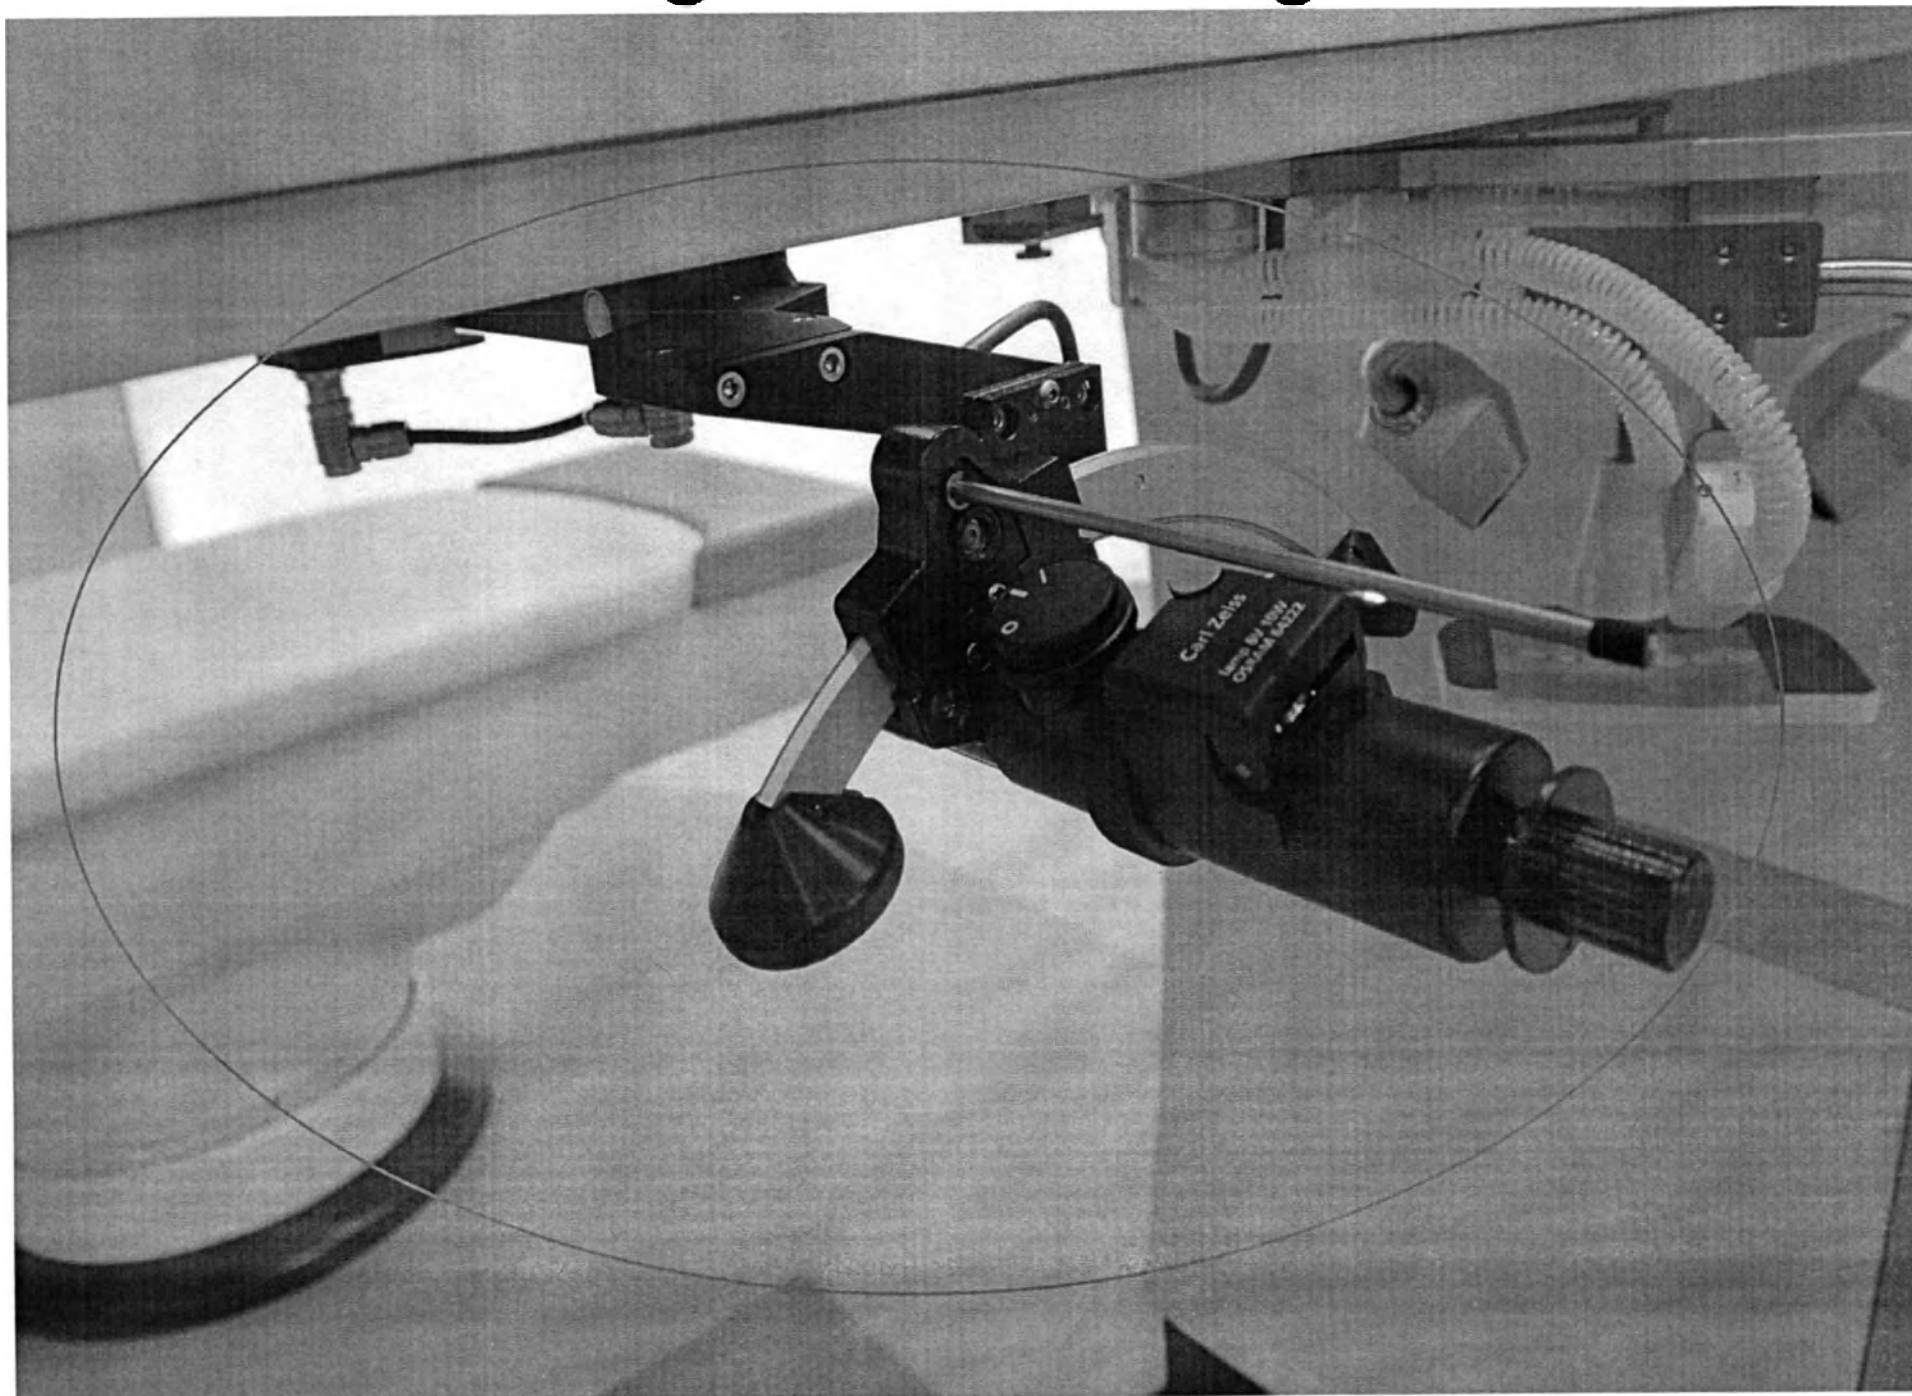

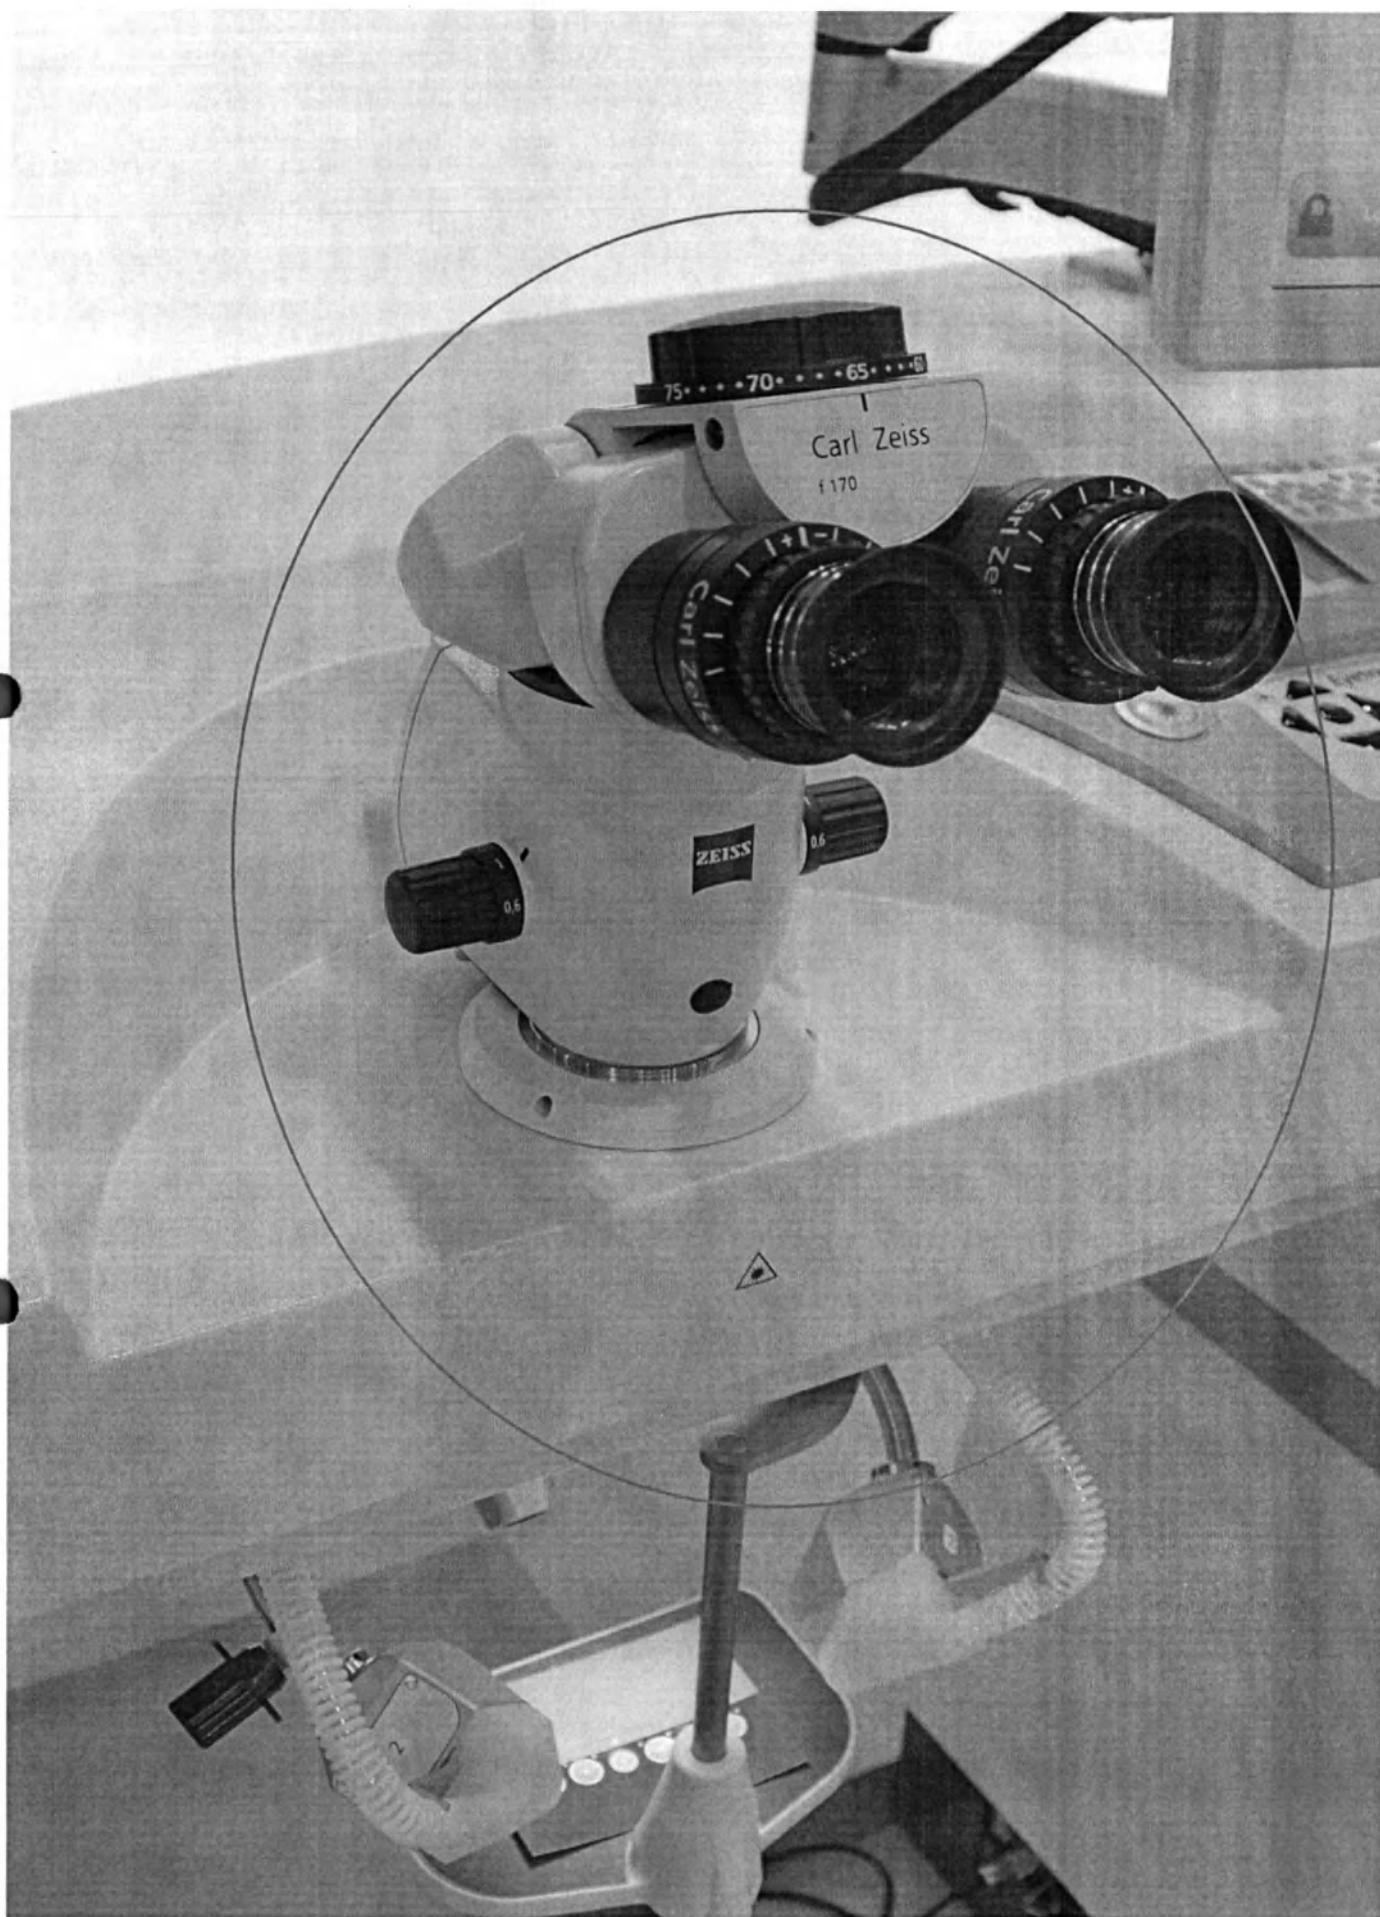

Блок визуализации.




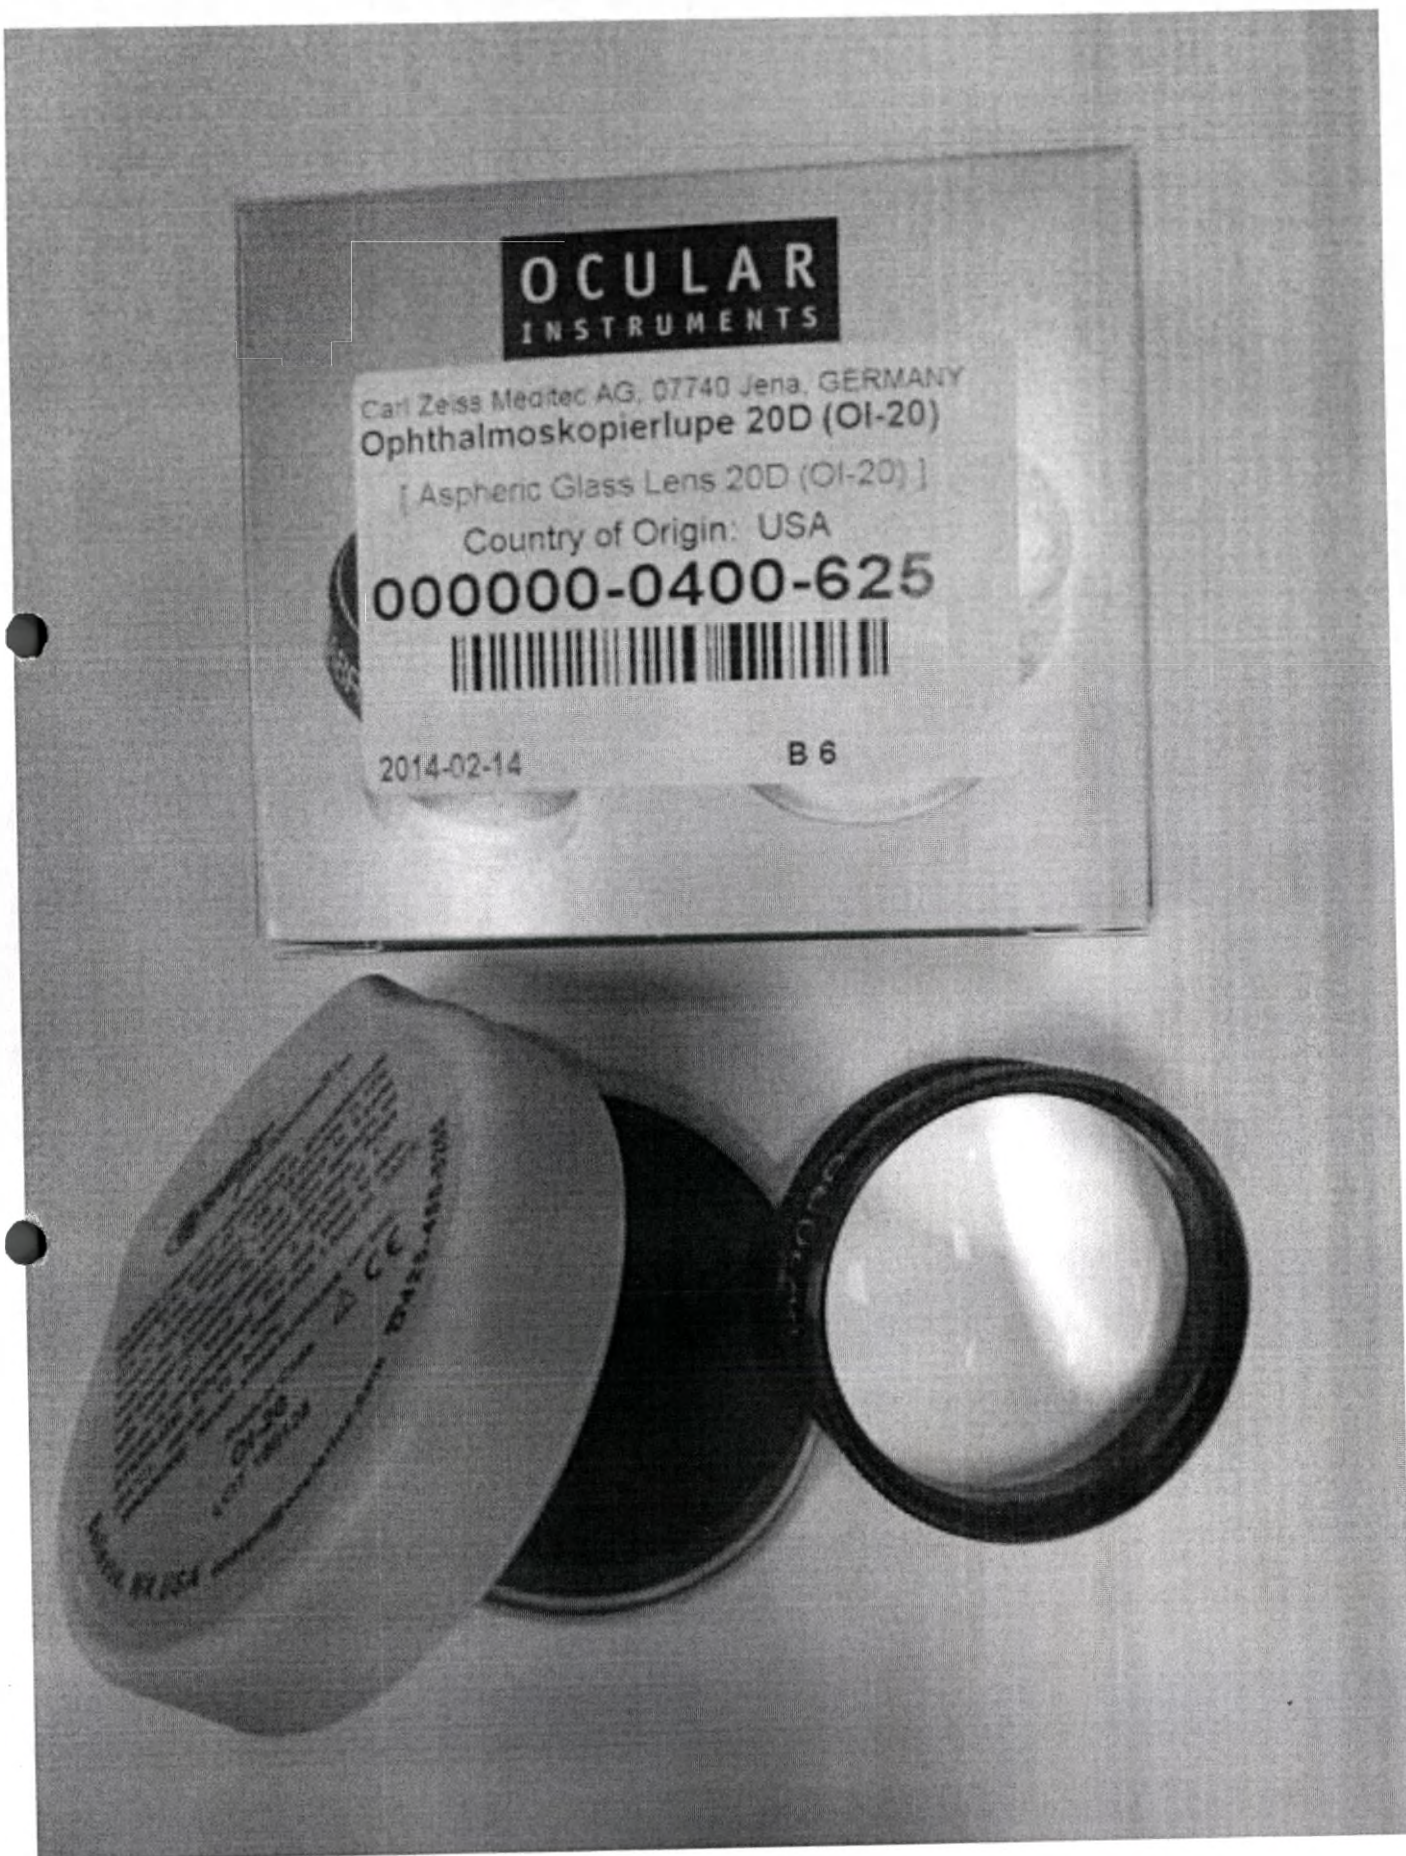


**OCULAR
INSTRUMENTS**

Carl Zeiss Meditec AG, 07740 Jena, GERMANY
Ophthalmoskopierlupe 20D (OI-20)
[Aspheric Glass Lens 20D (OI-20)]
Country of Origin: USA
000000-0400-625
2014-02-14 B 6

Делитель луча.

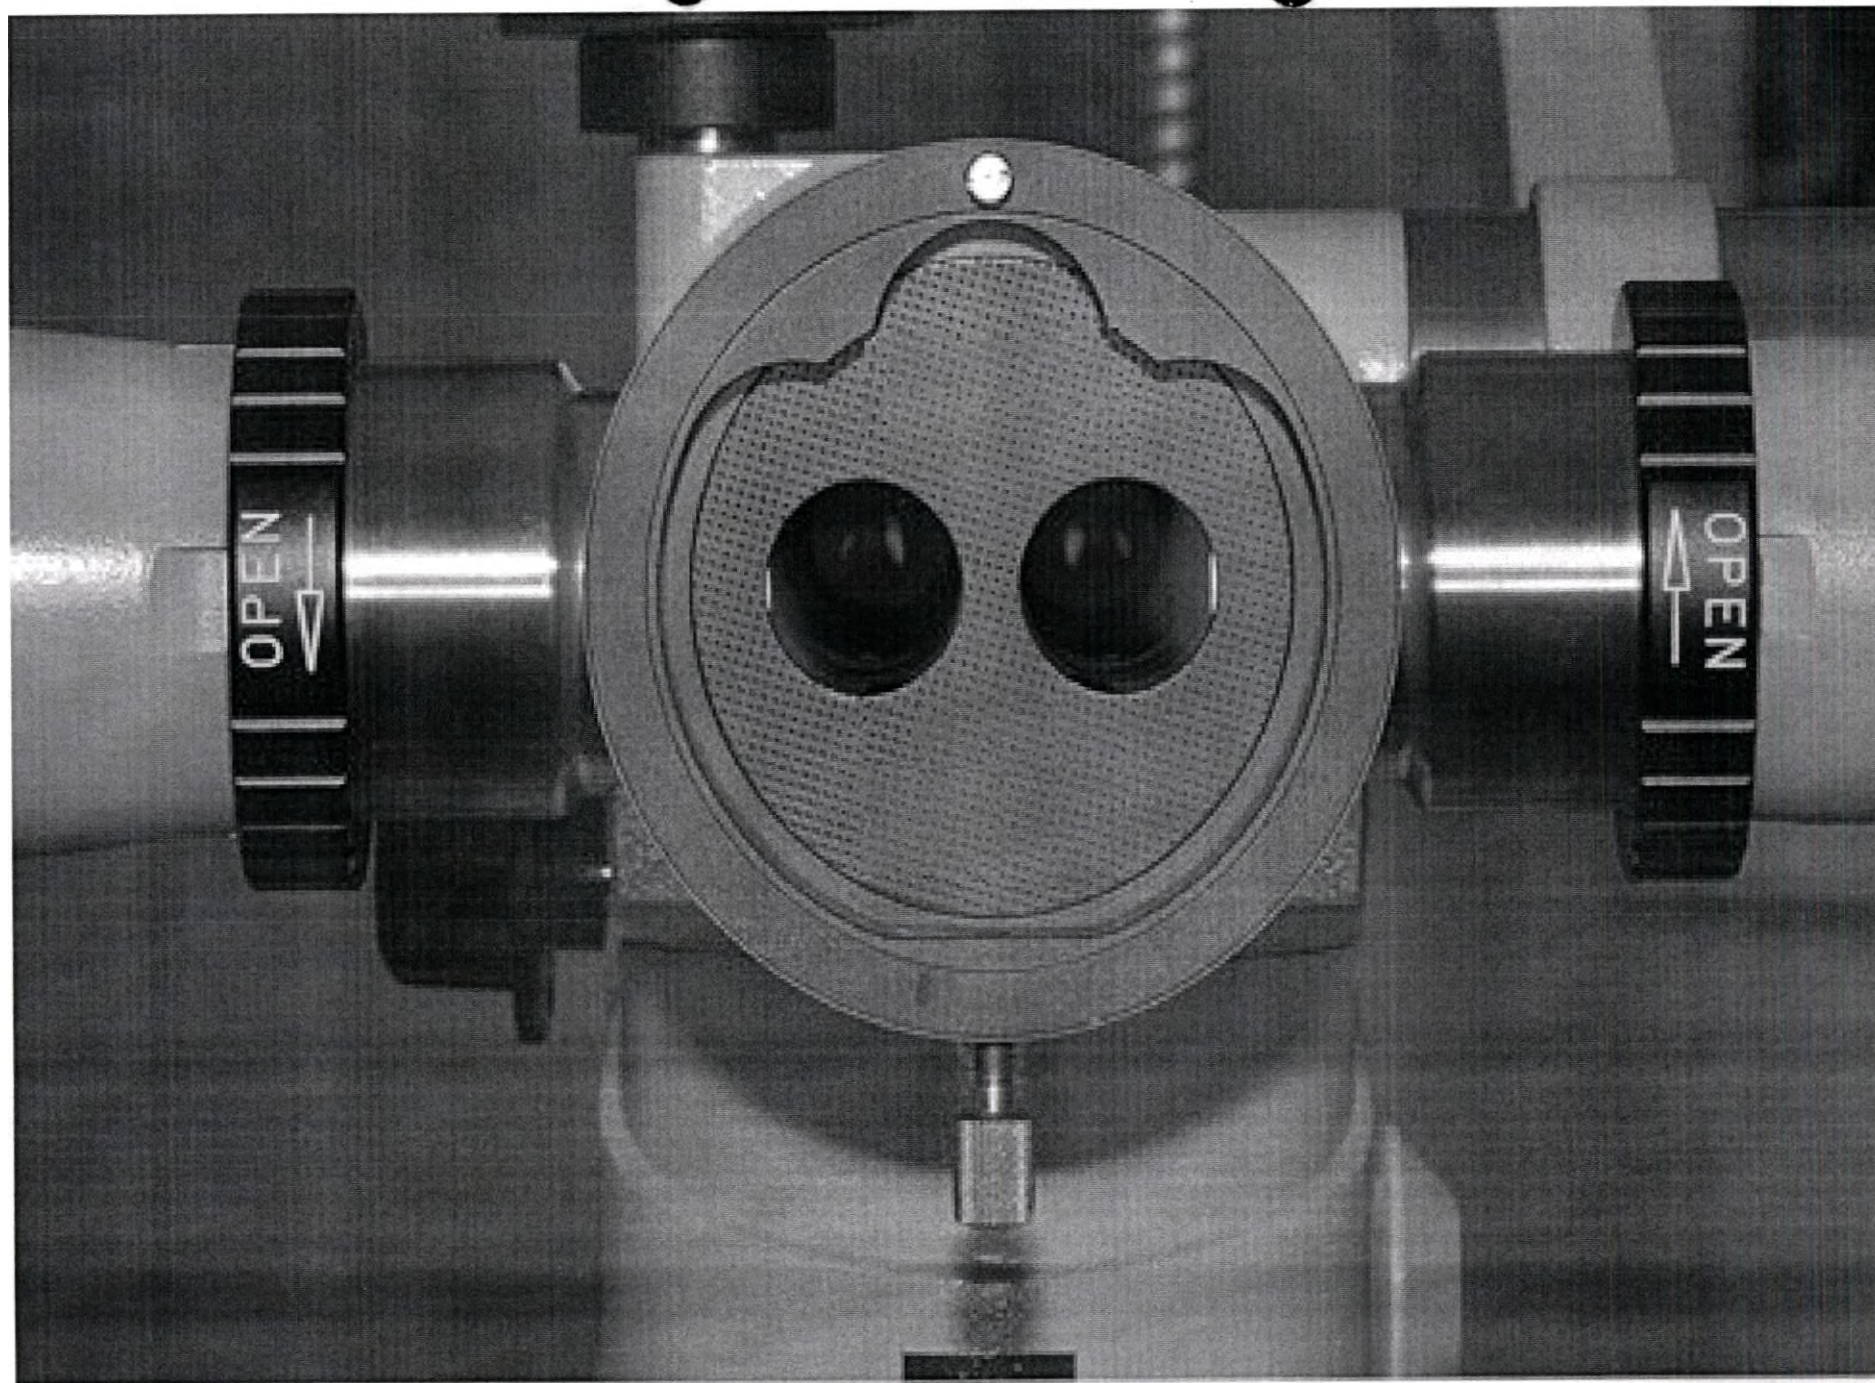

Монитор ассистента специальный.

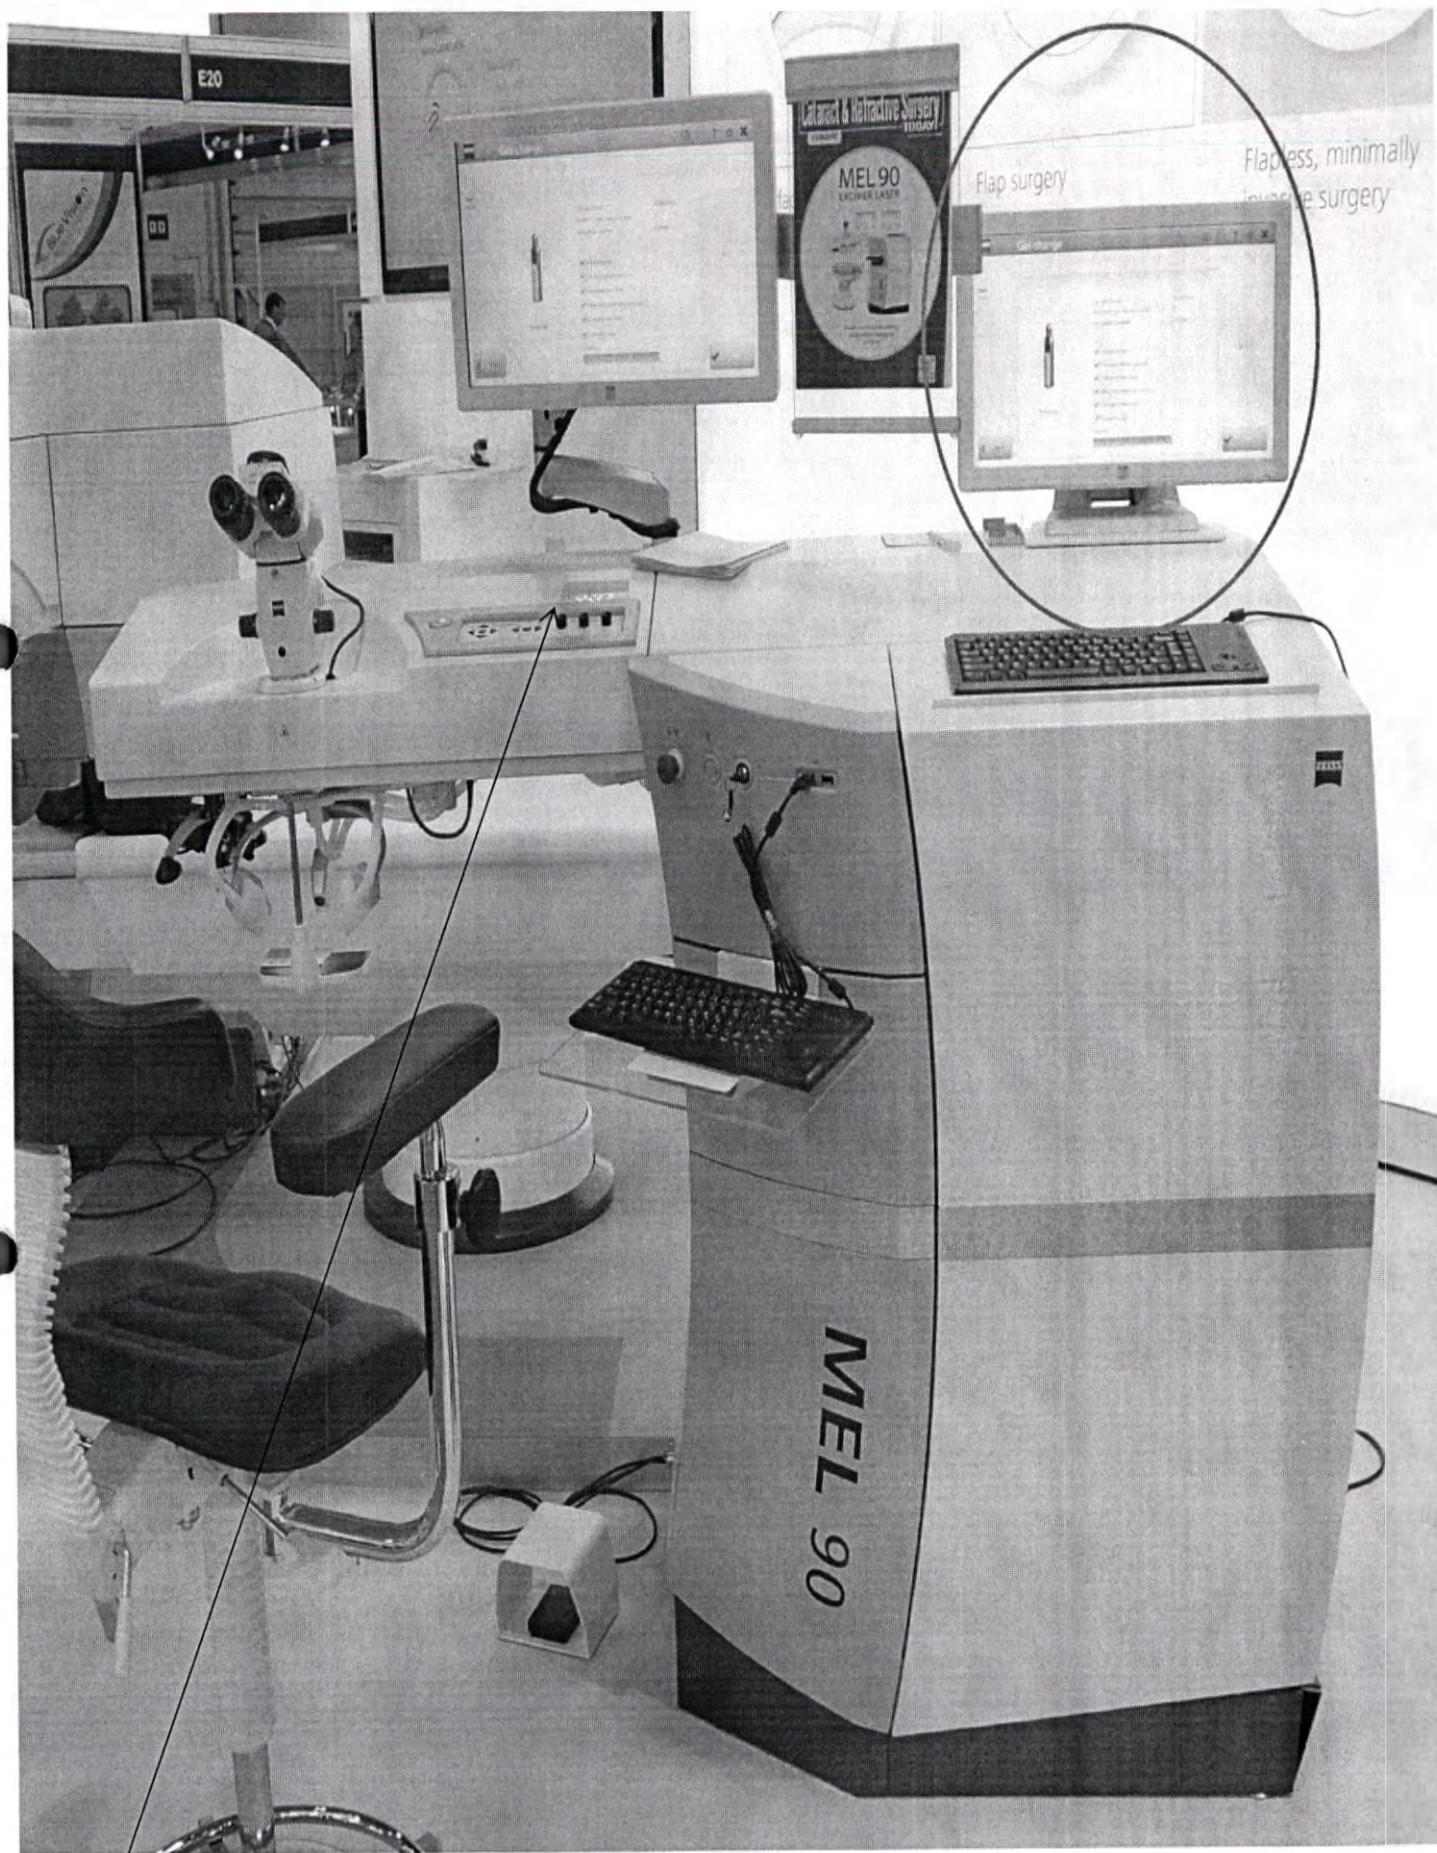

Управляющий компьютер к устройству для анализа оптической аберрации глаза.


Управляющий компьютер к корнеотопографу Atlas.

Системный блок управления лазером.




Стол врача со встроенным системным блоком, блоком питания

Монитор специальный (не более 2 шт.).

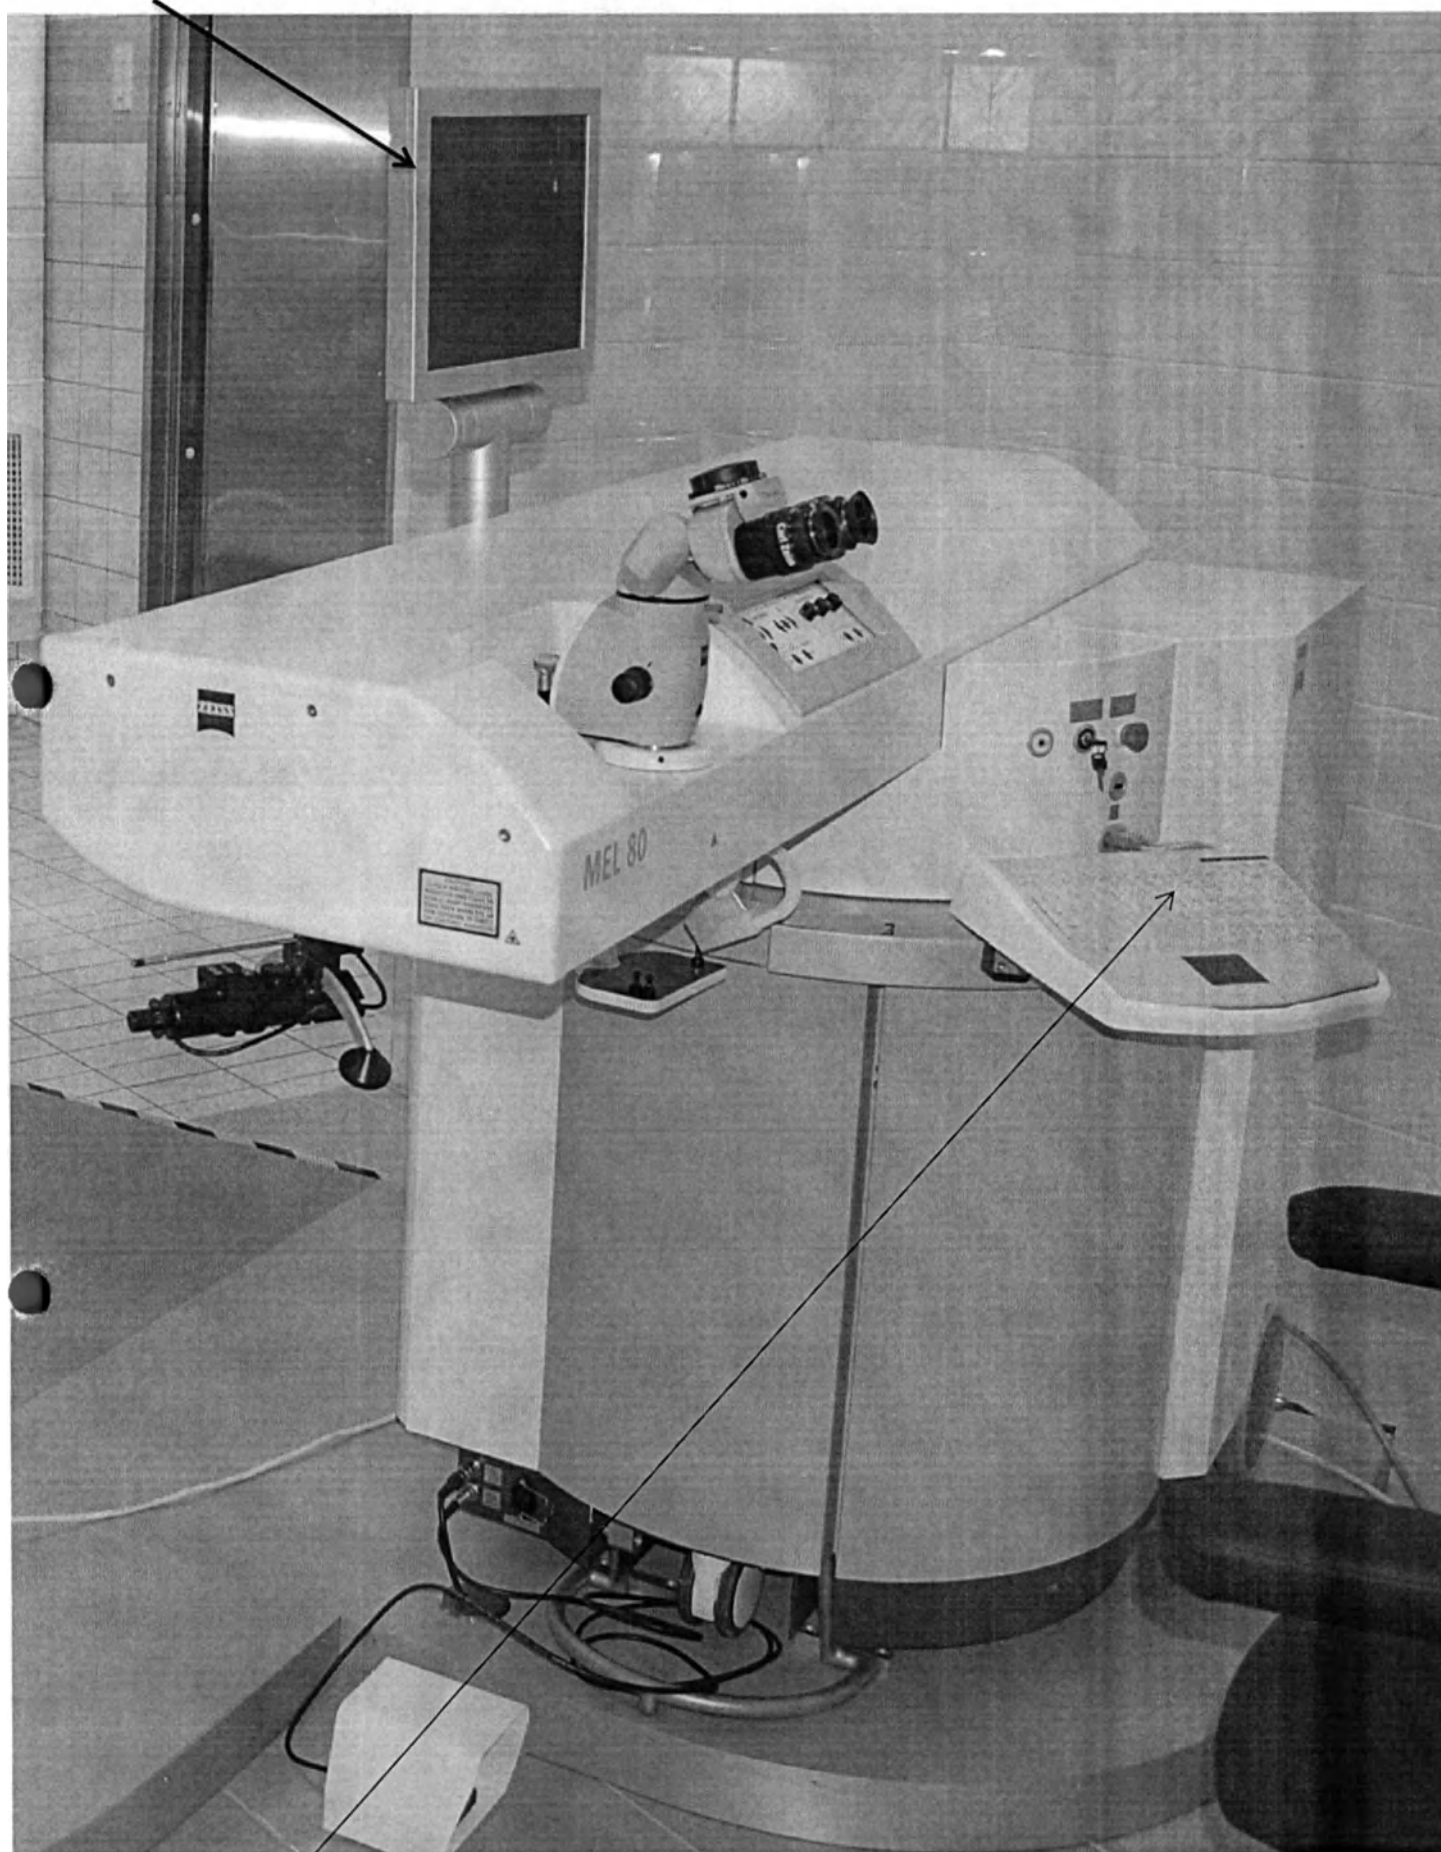


Клавиатура специальная (не более 4 шт.).

Держатель клавиатуры специальной.

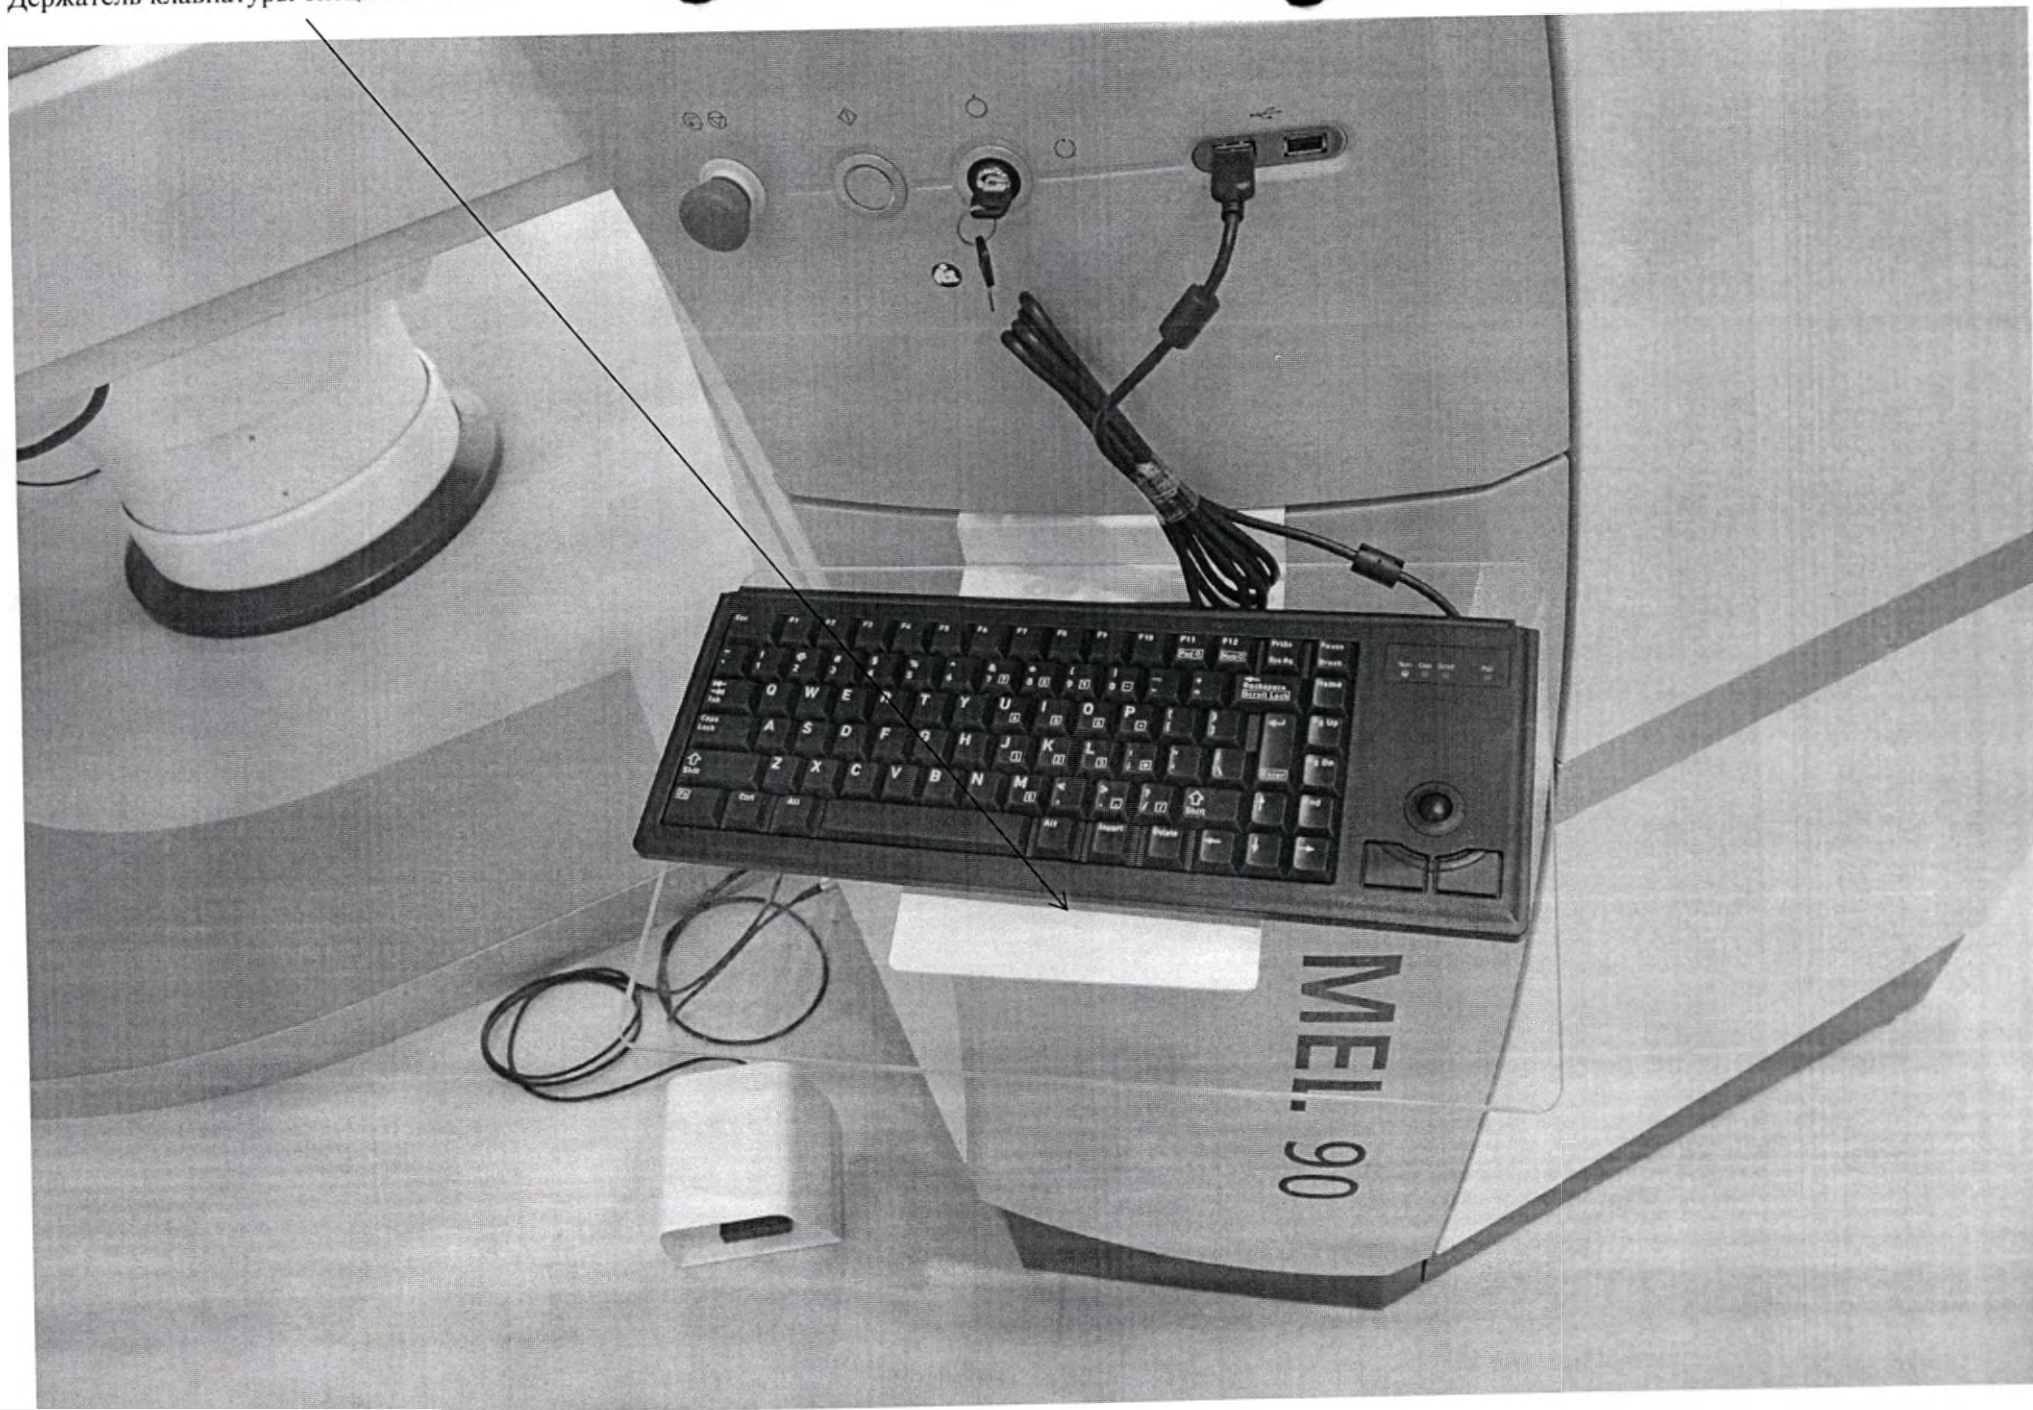


Съемный носитель со специальным программным обеспечением (не более 20 шт.).
Съемный носитель (не более 20 шт.).

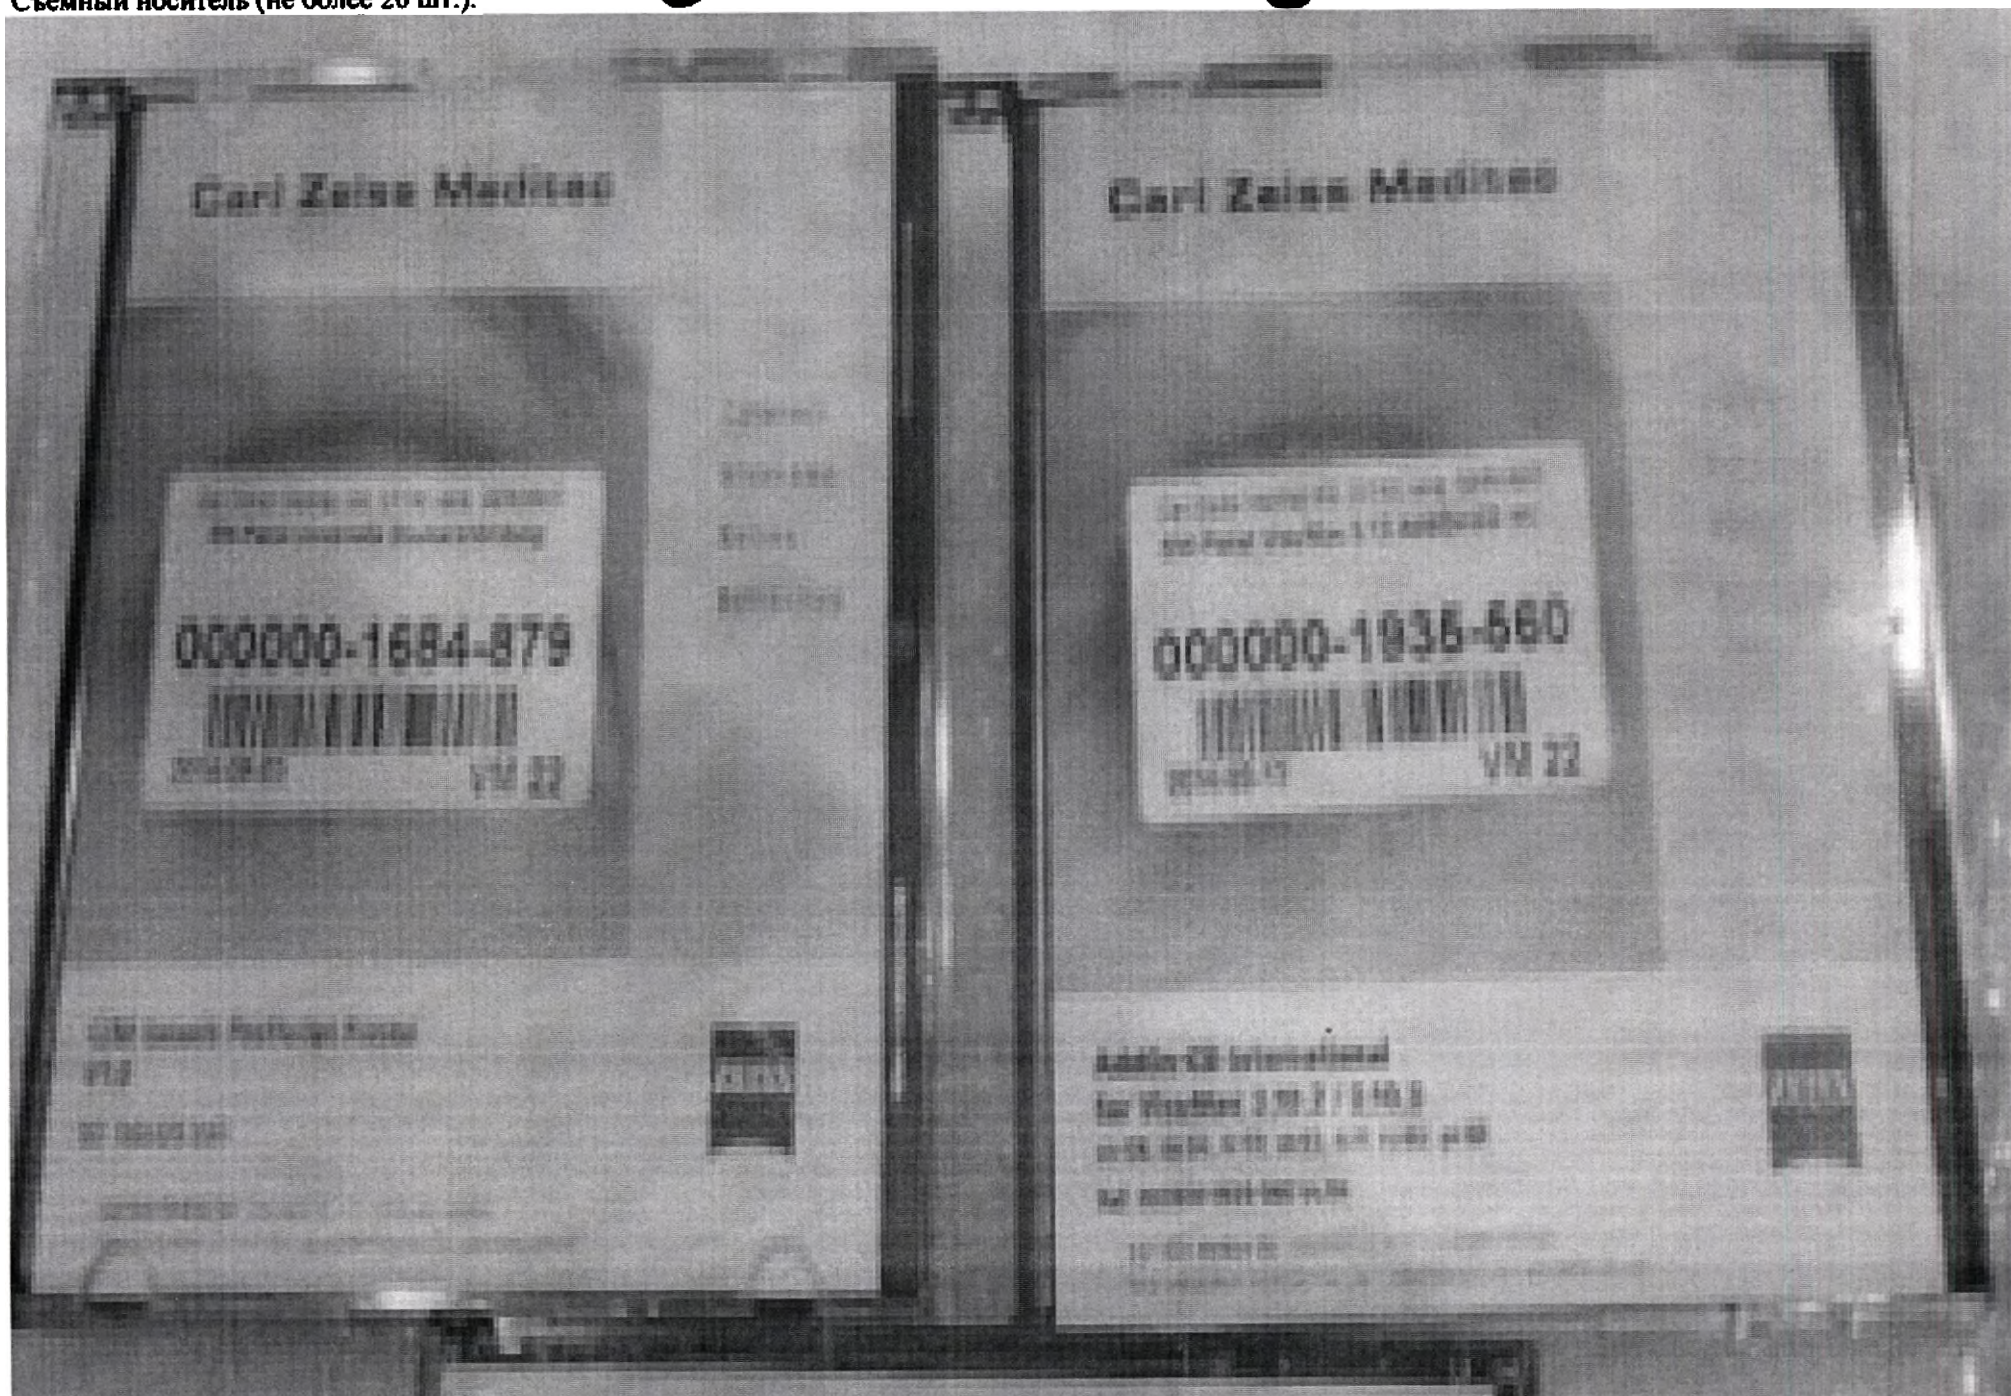


Карта с электронным чипом (не более 5 шт.).




Адаптер сетевой (не более 5 шт.).

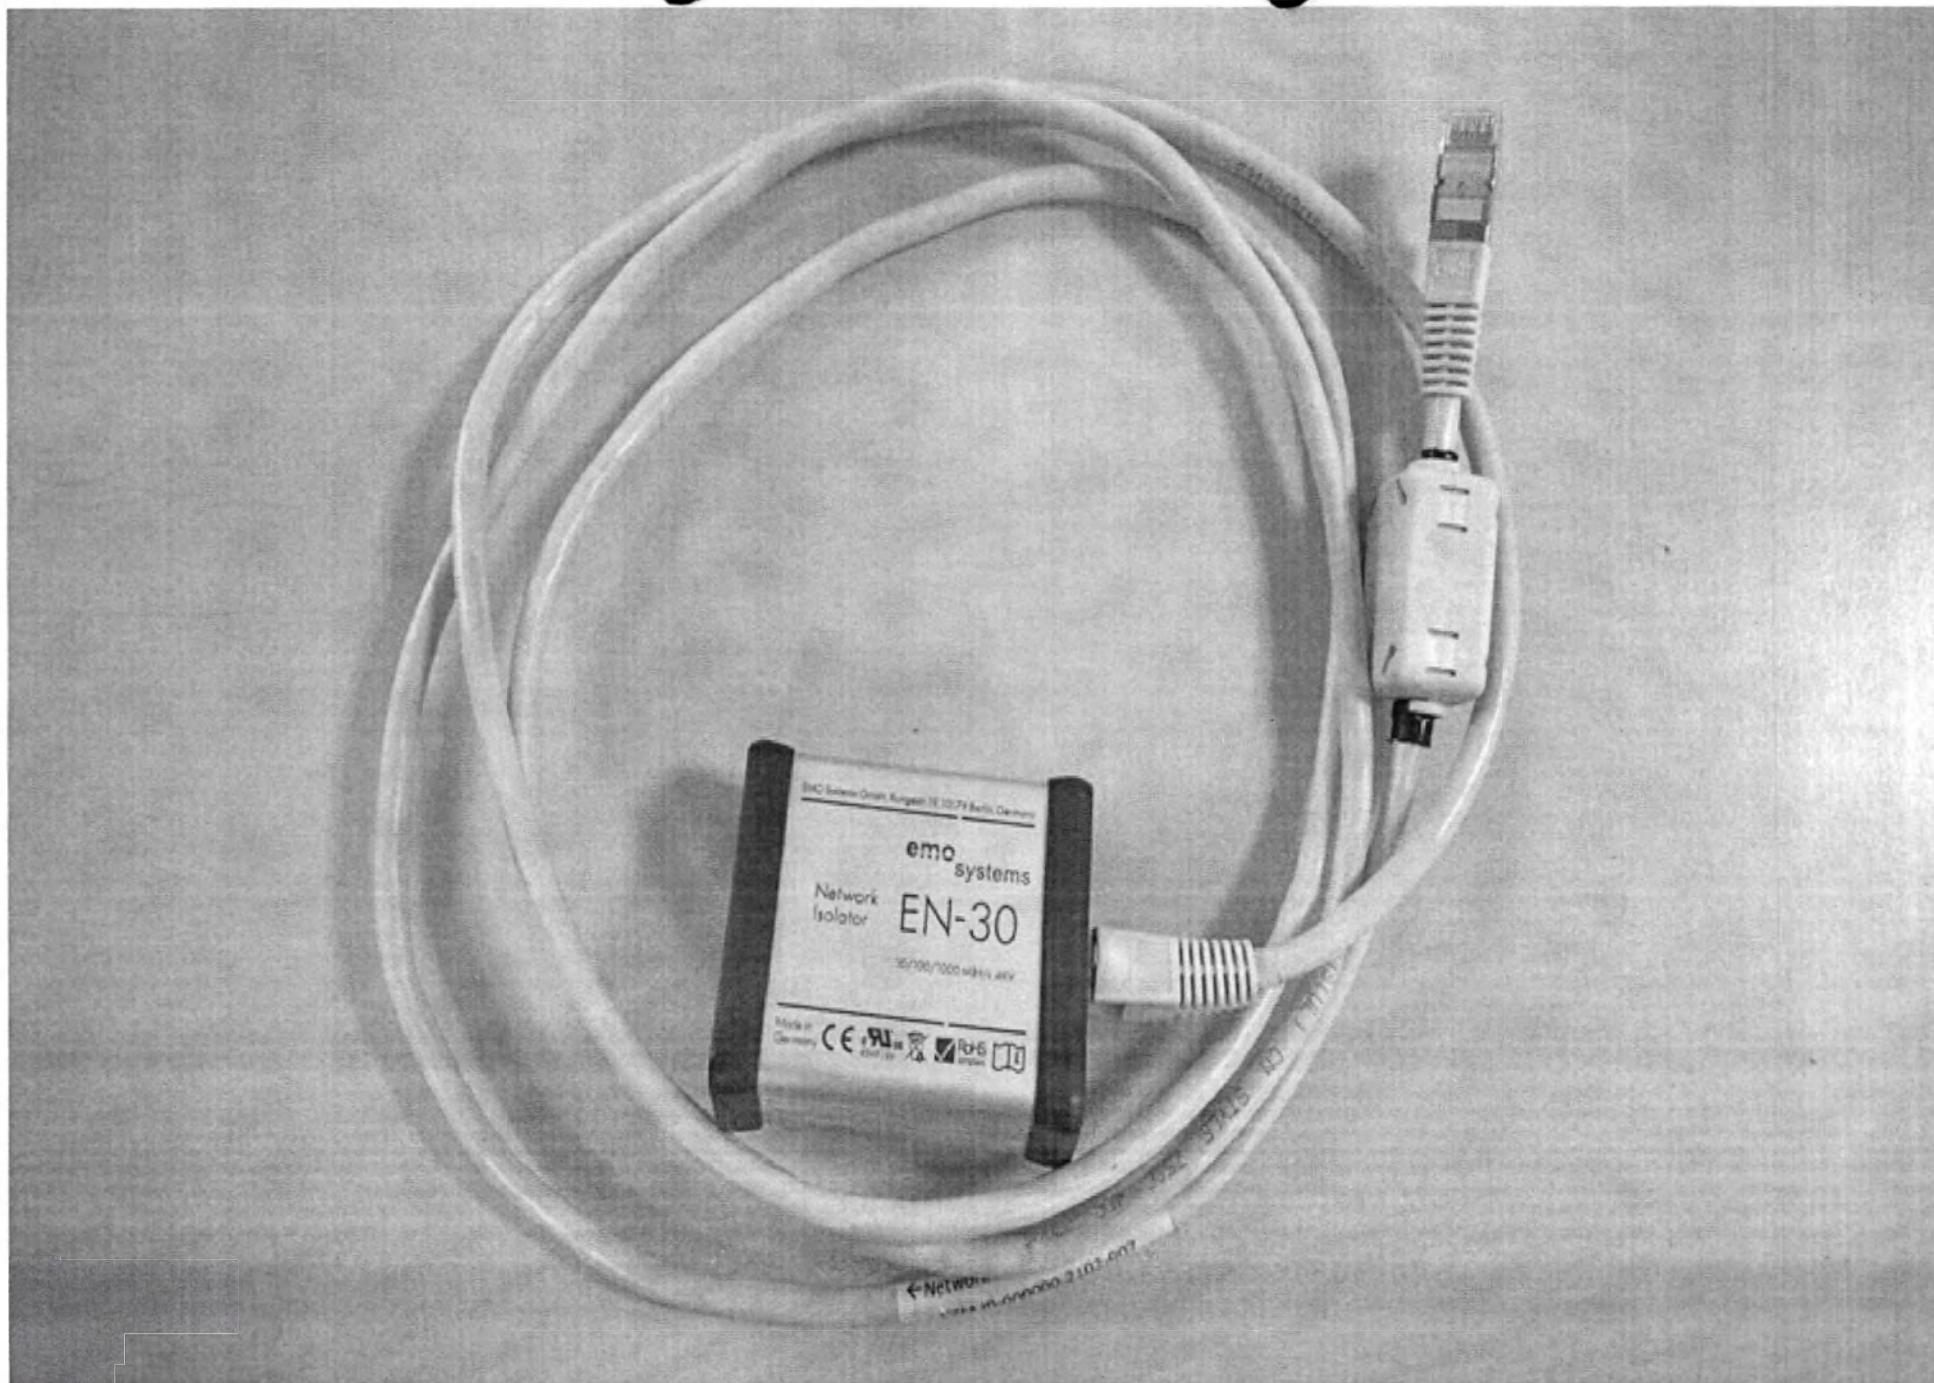


Кабели сетевые, соединительные (не более 30 шт.).

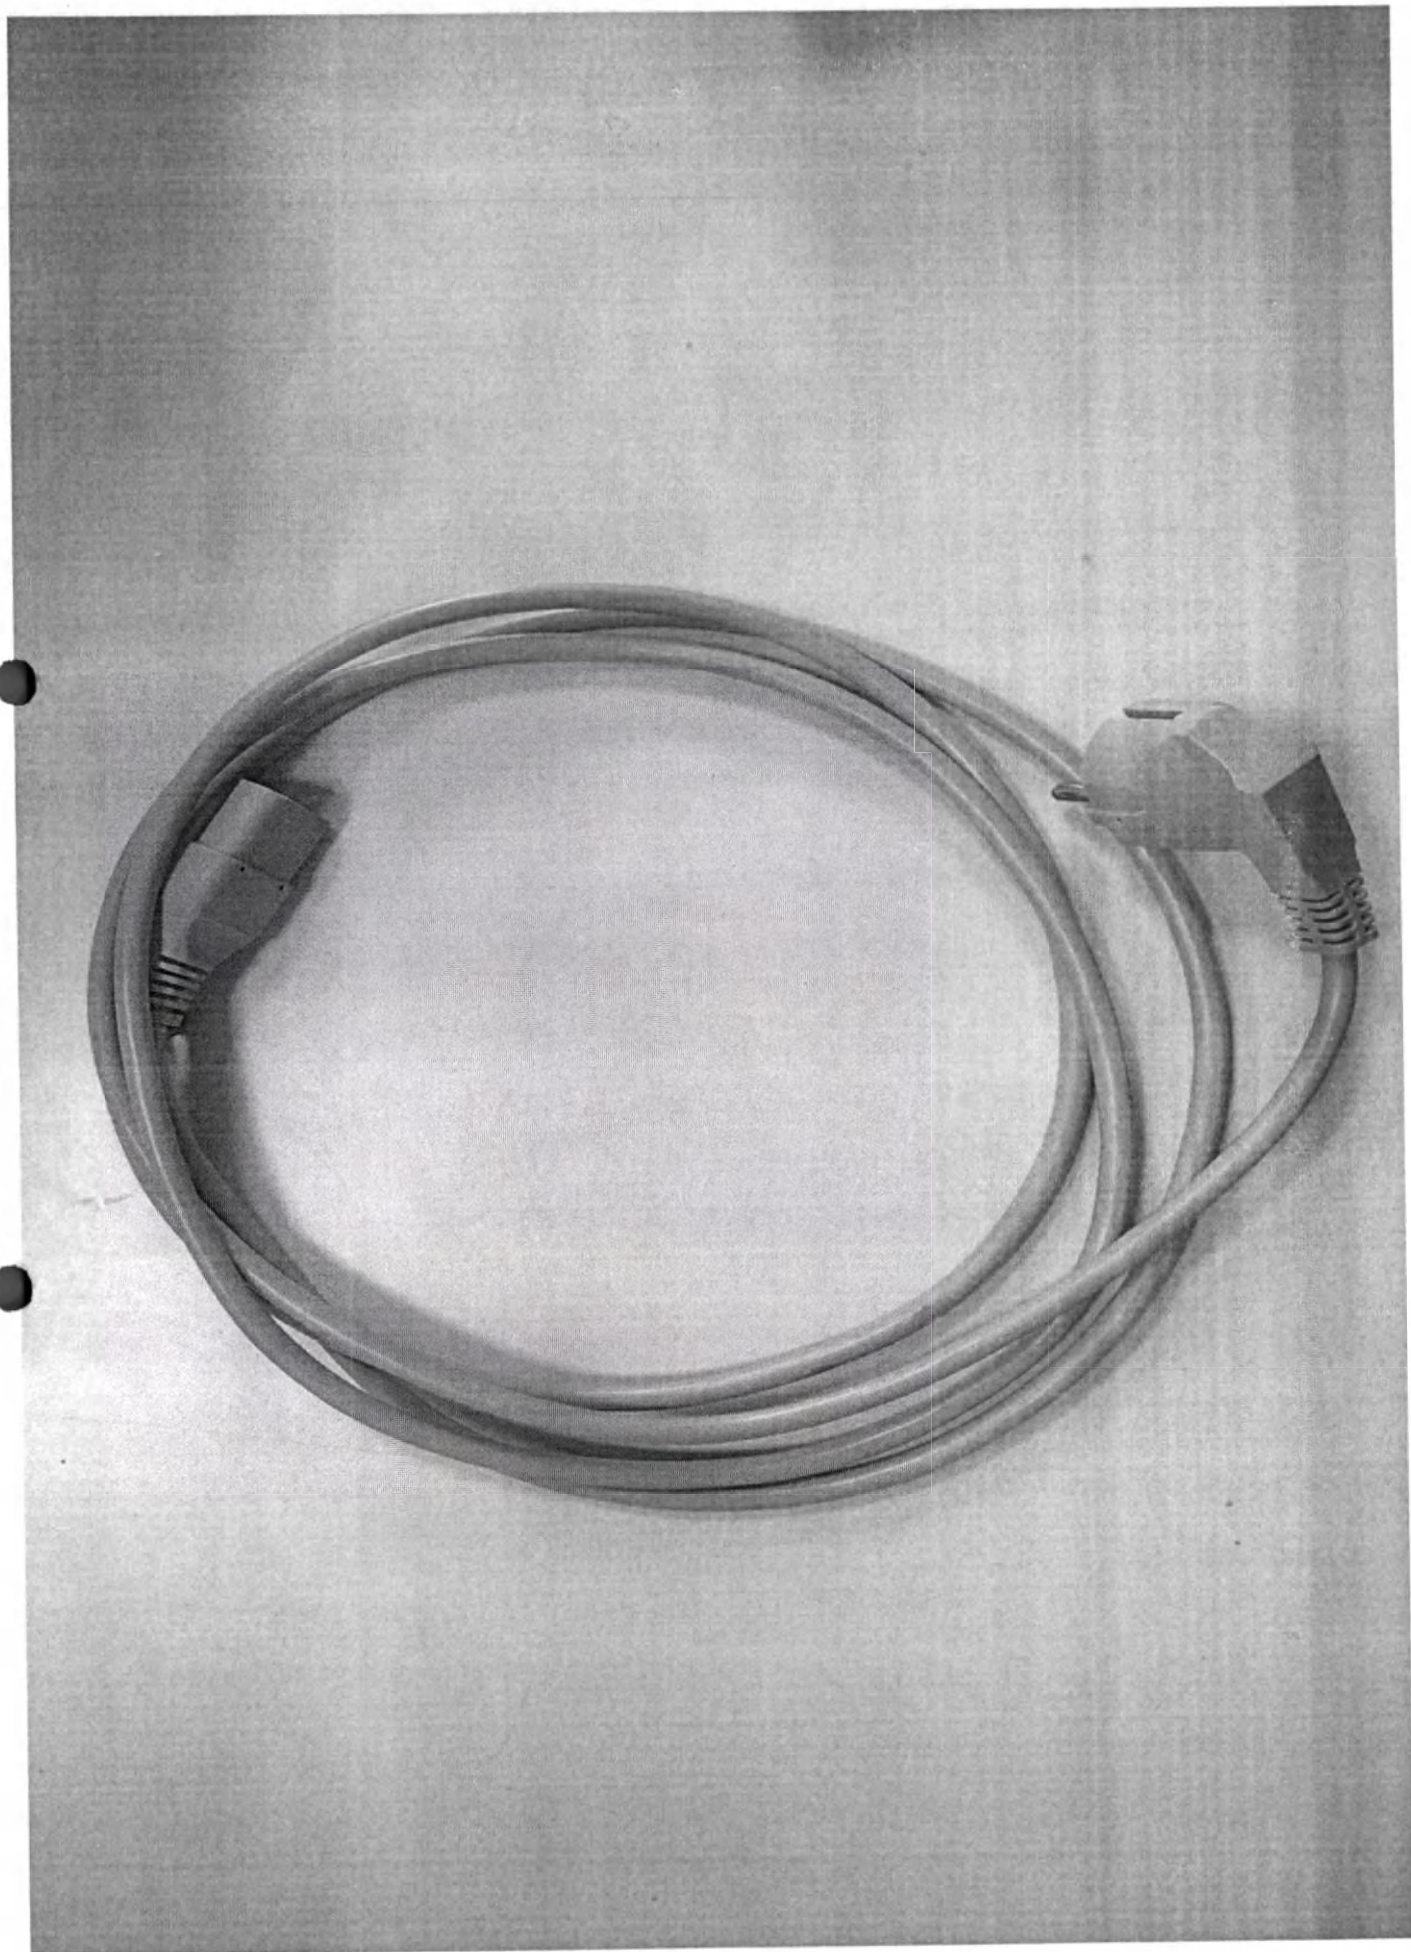


Адаптеры для колпачков защитных (не более 6 уп.).

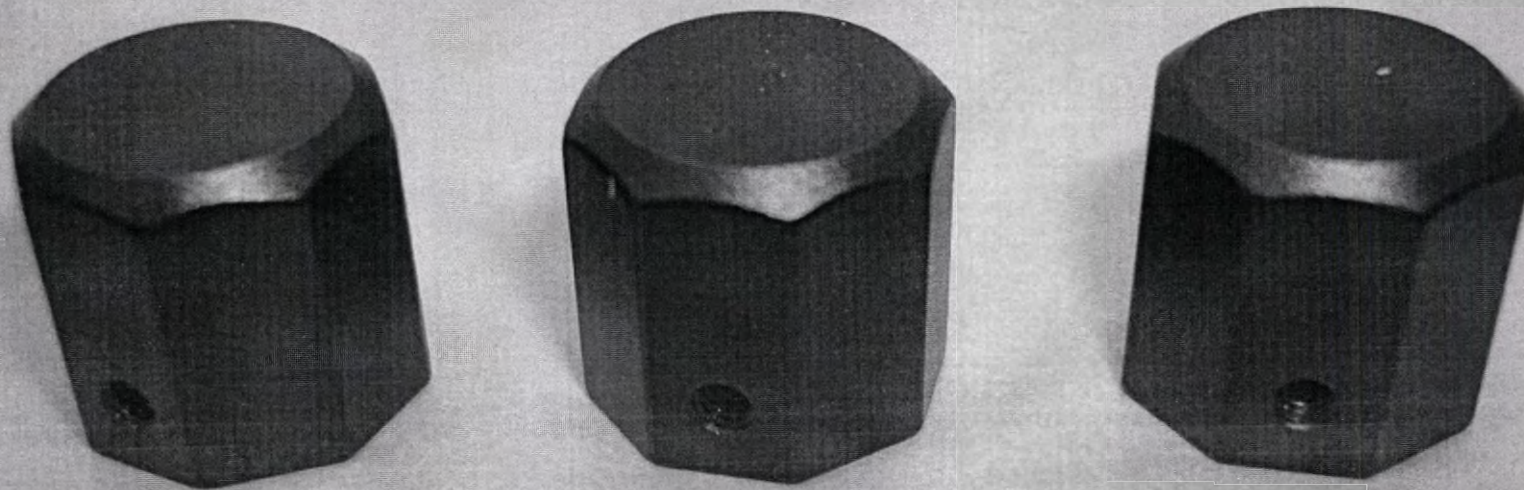


Держатель документов (не более 5 шт.).

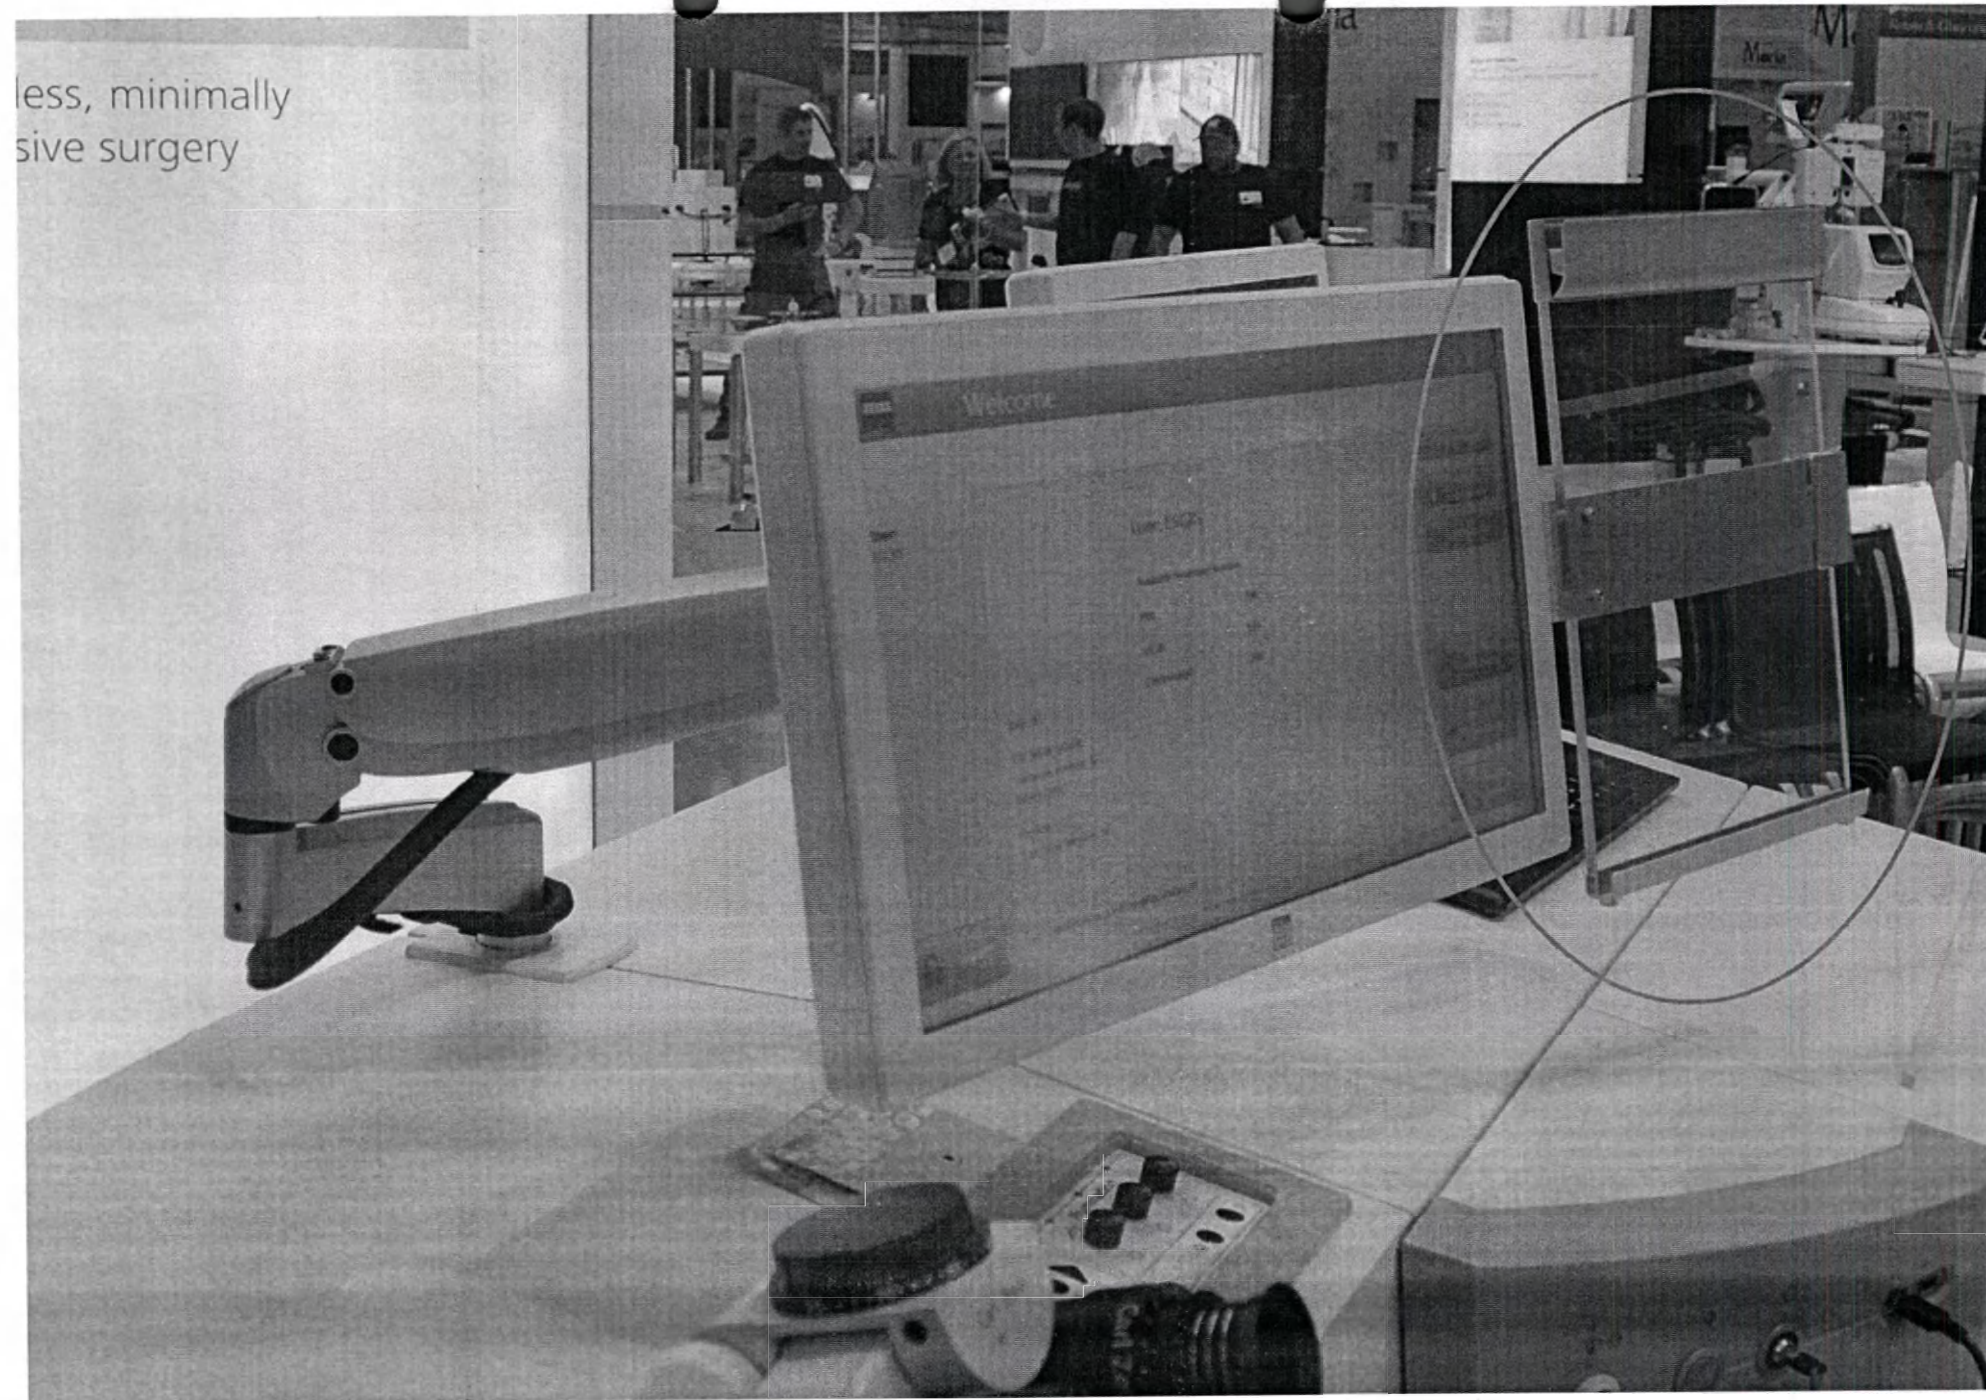


Стилус (не более 2 шт.).

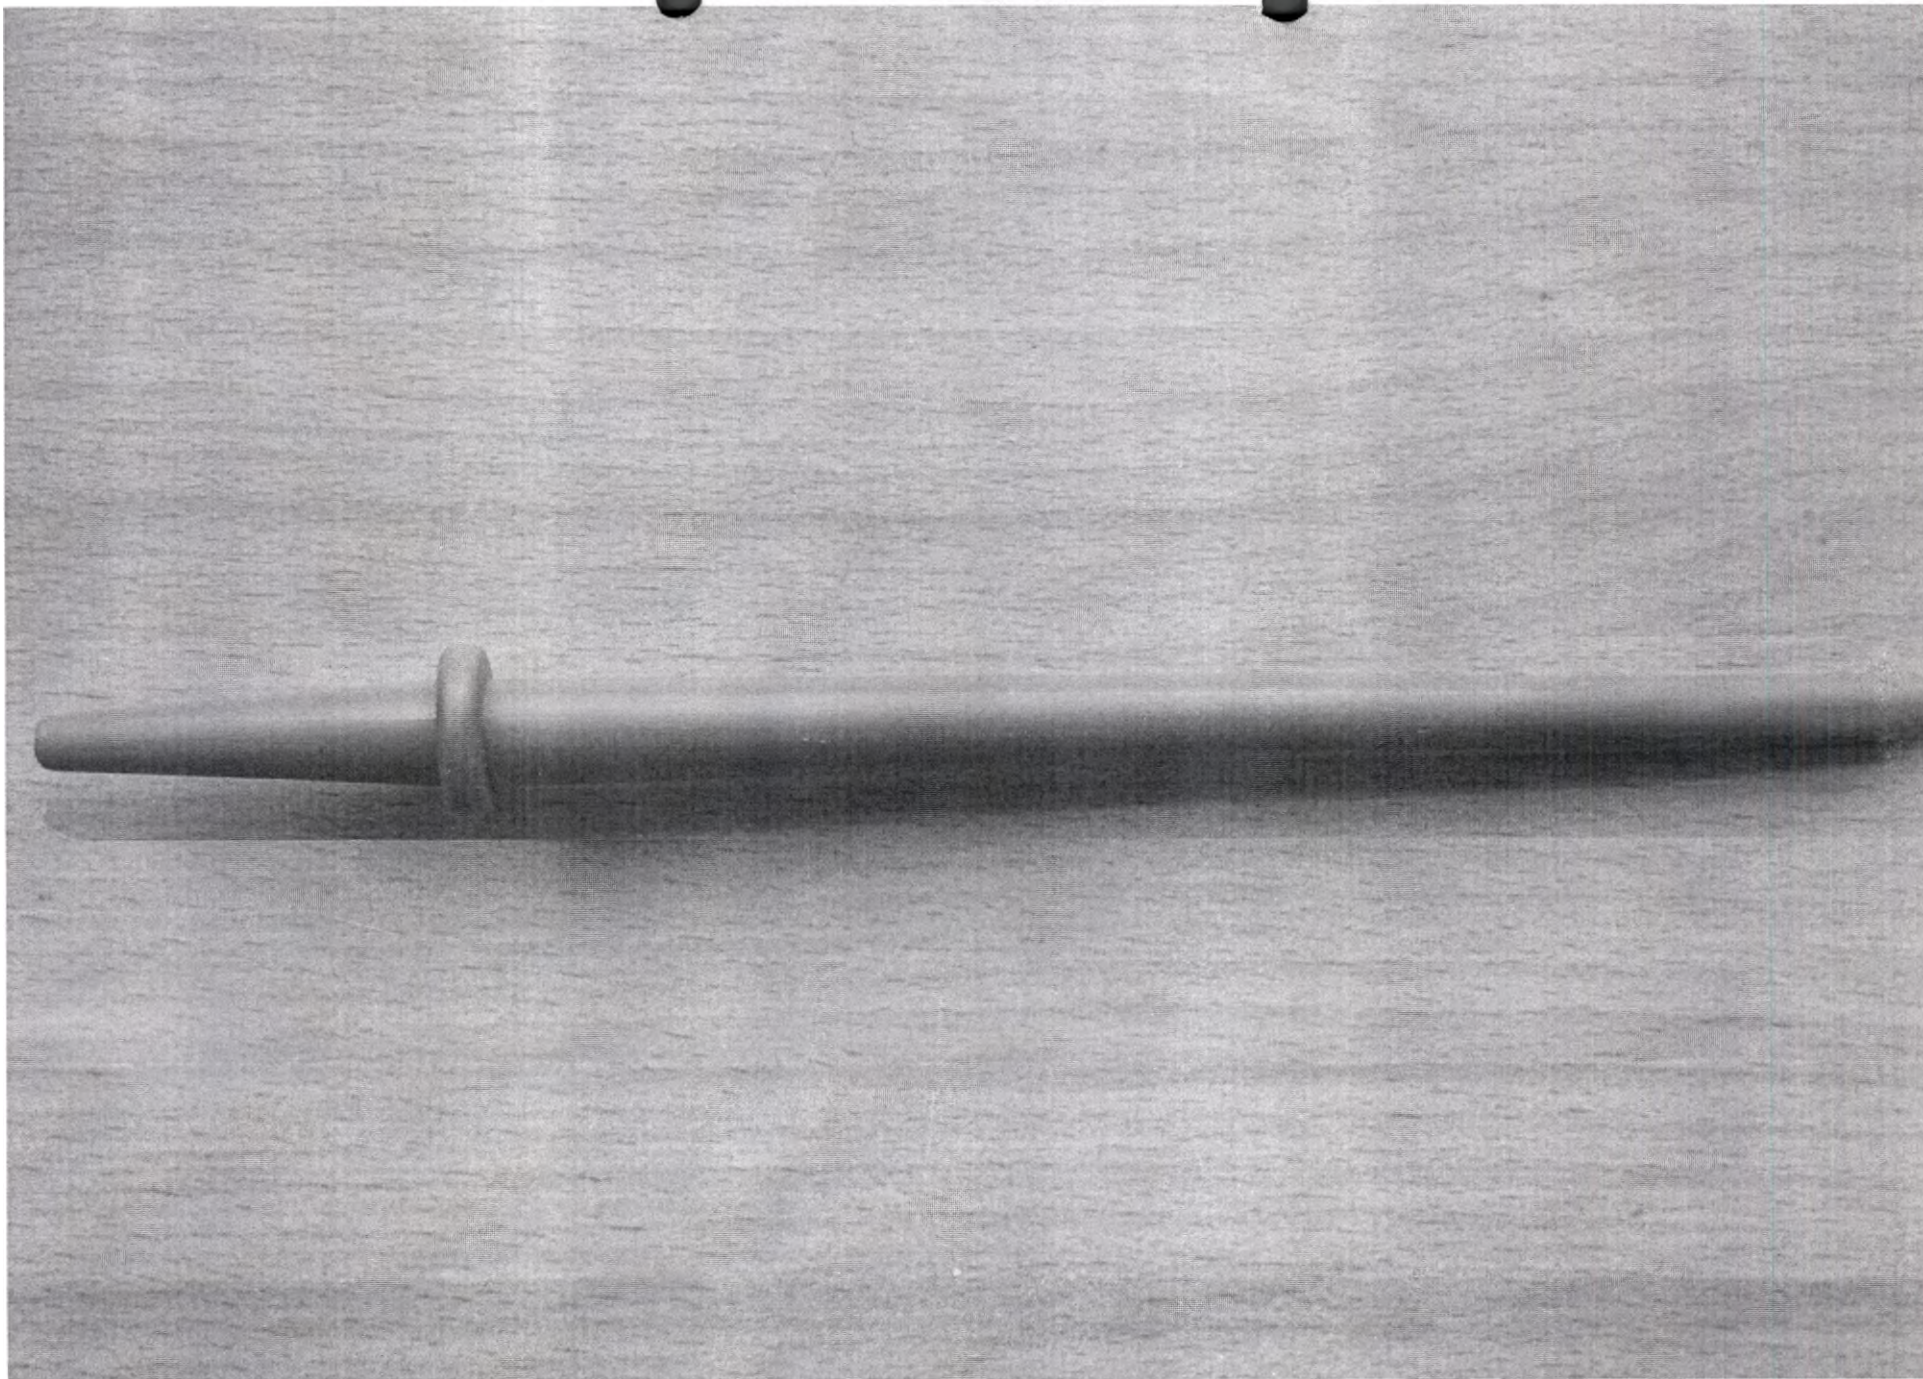


Держатель стилуса (не более 2 шт.).

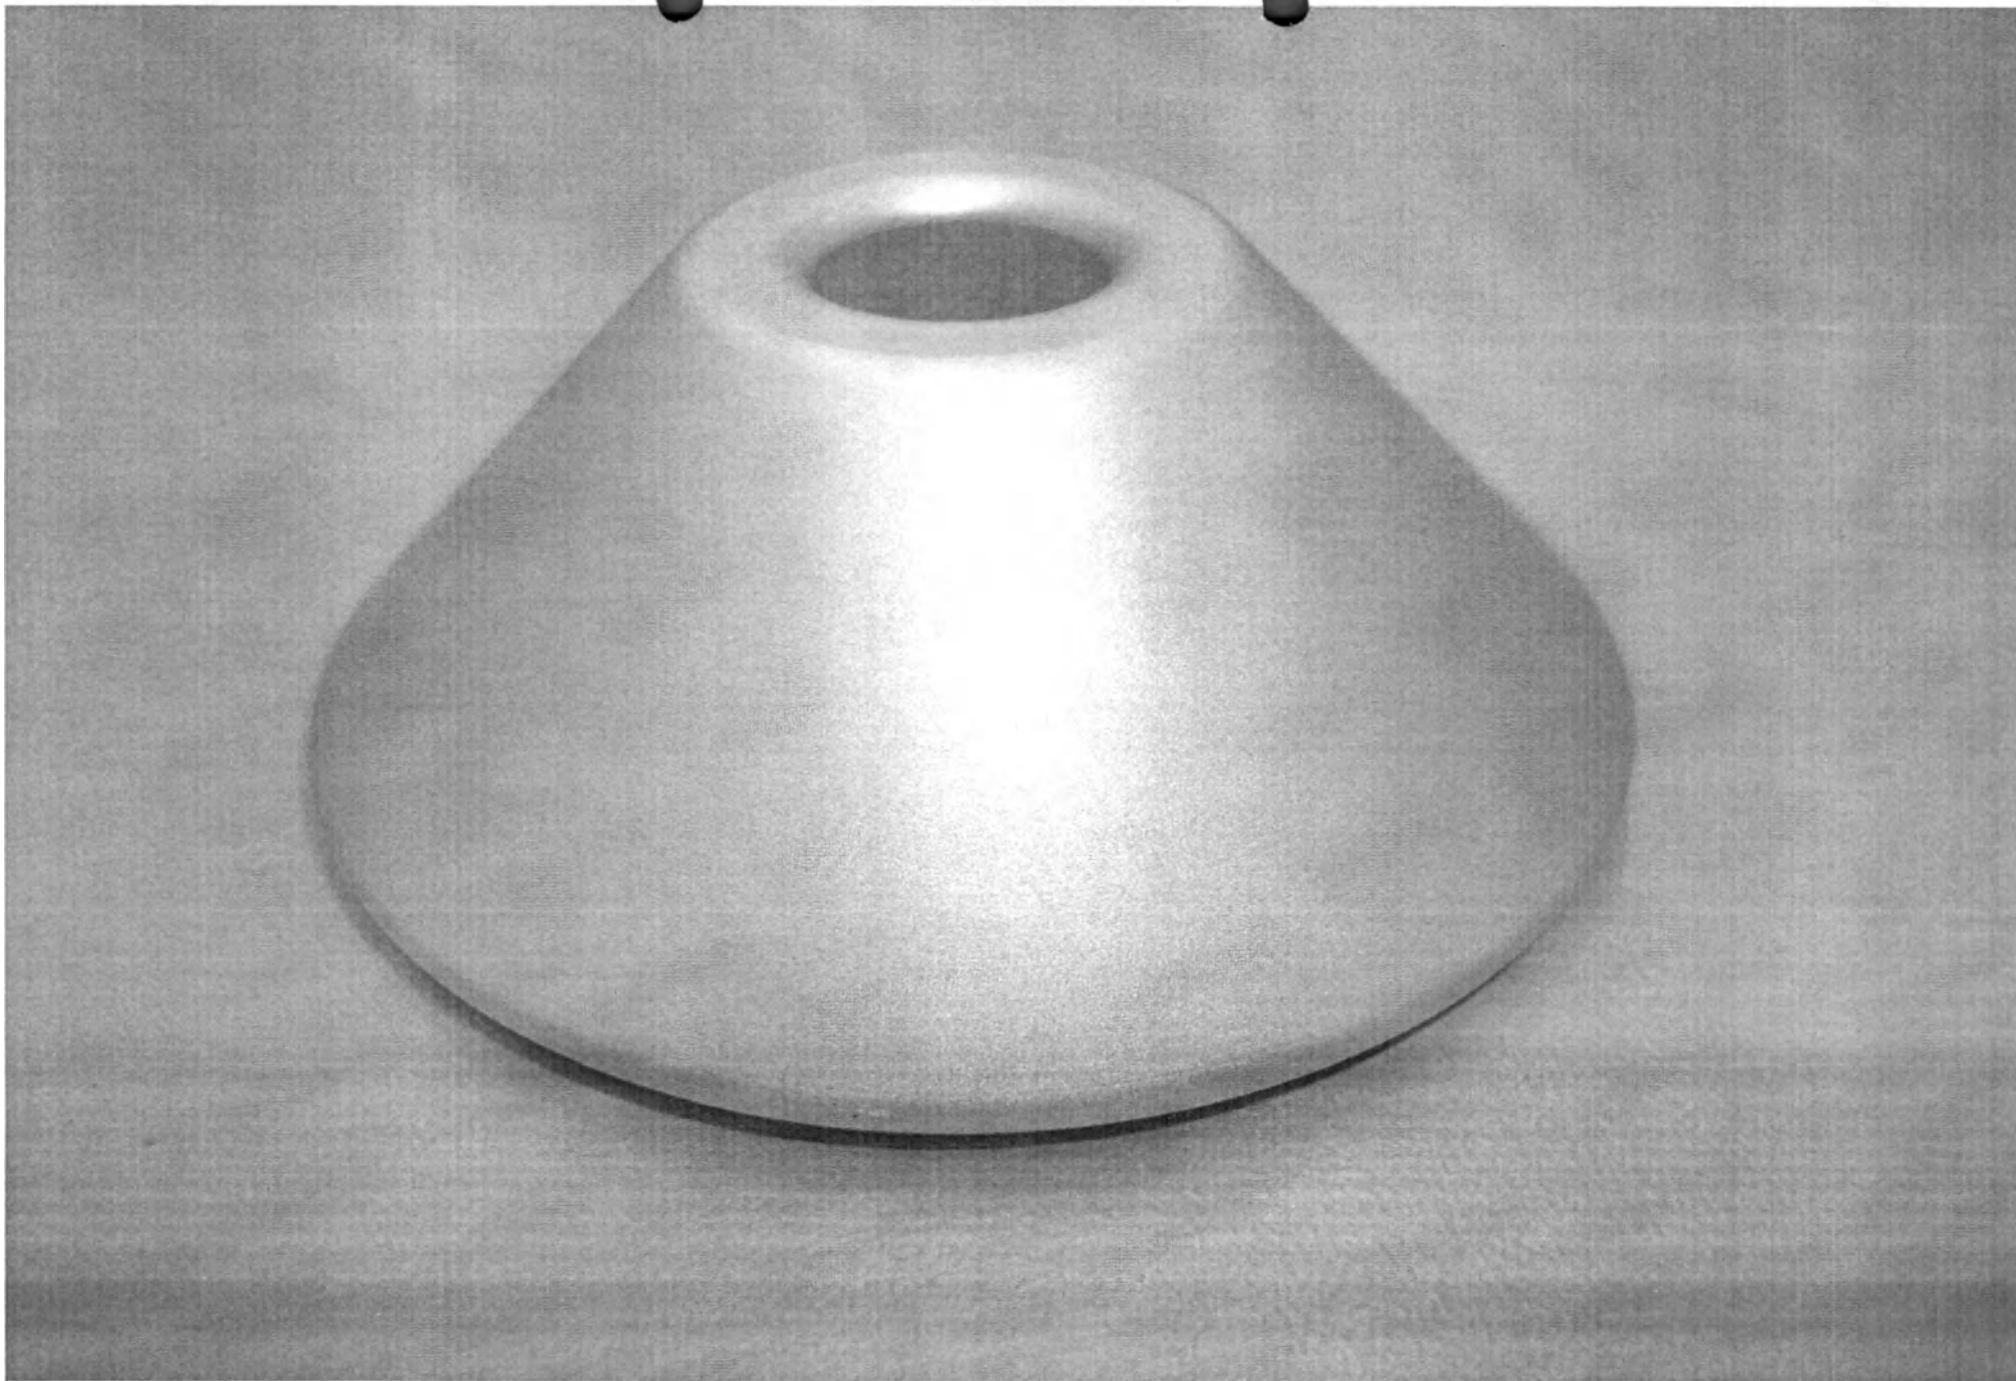


Заглушка (не более 3 шт.).

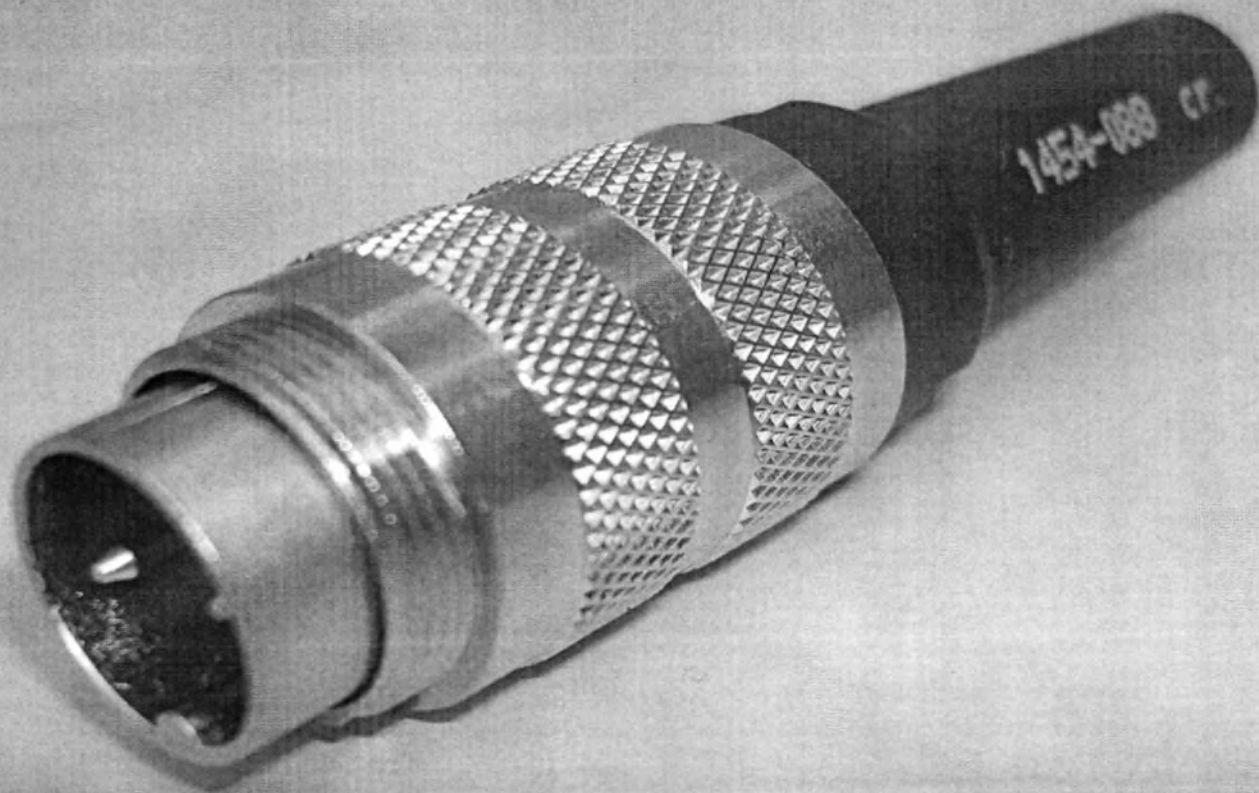


Колпачки защитные (не более 4 уп.).

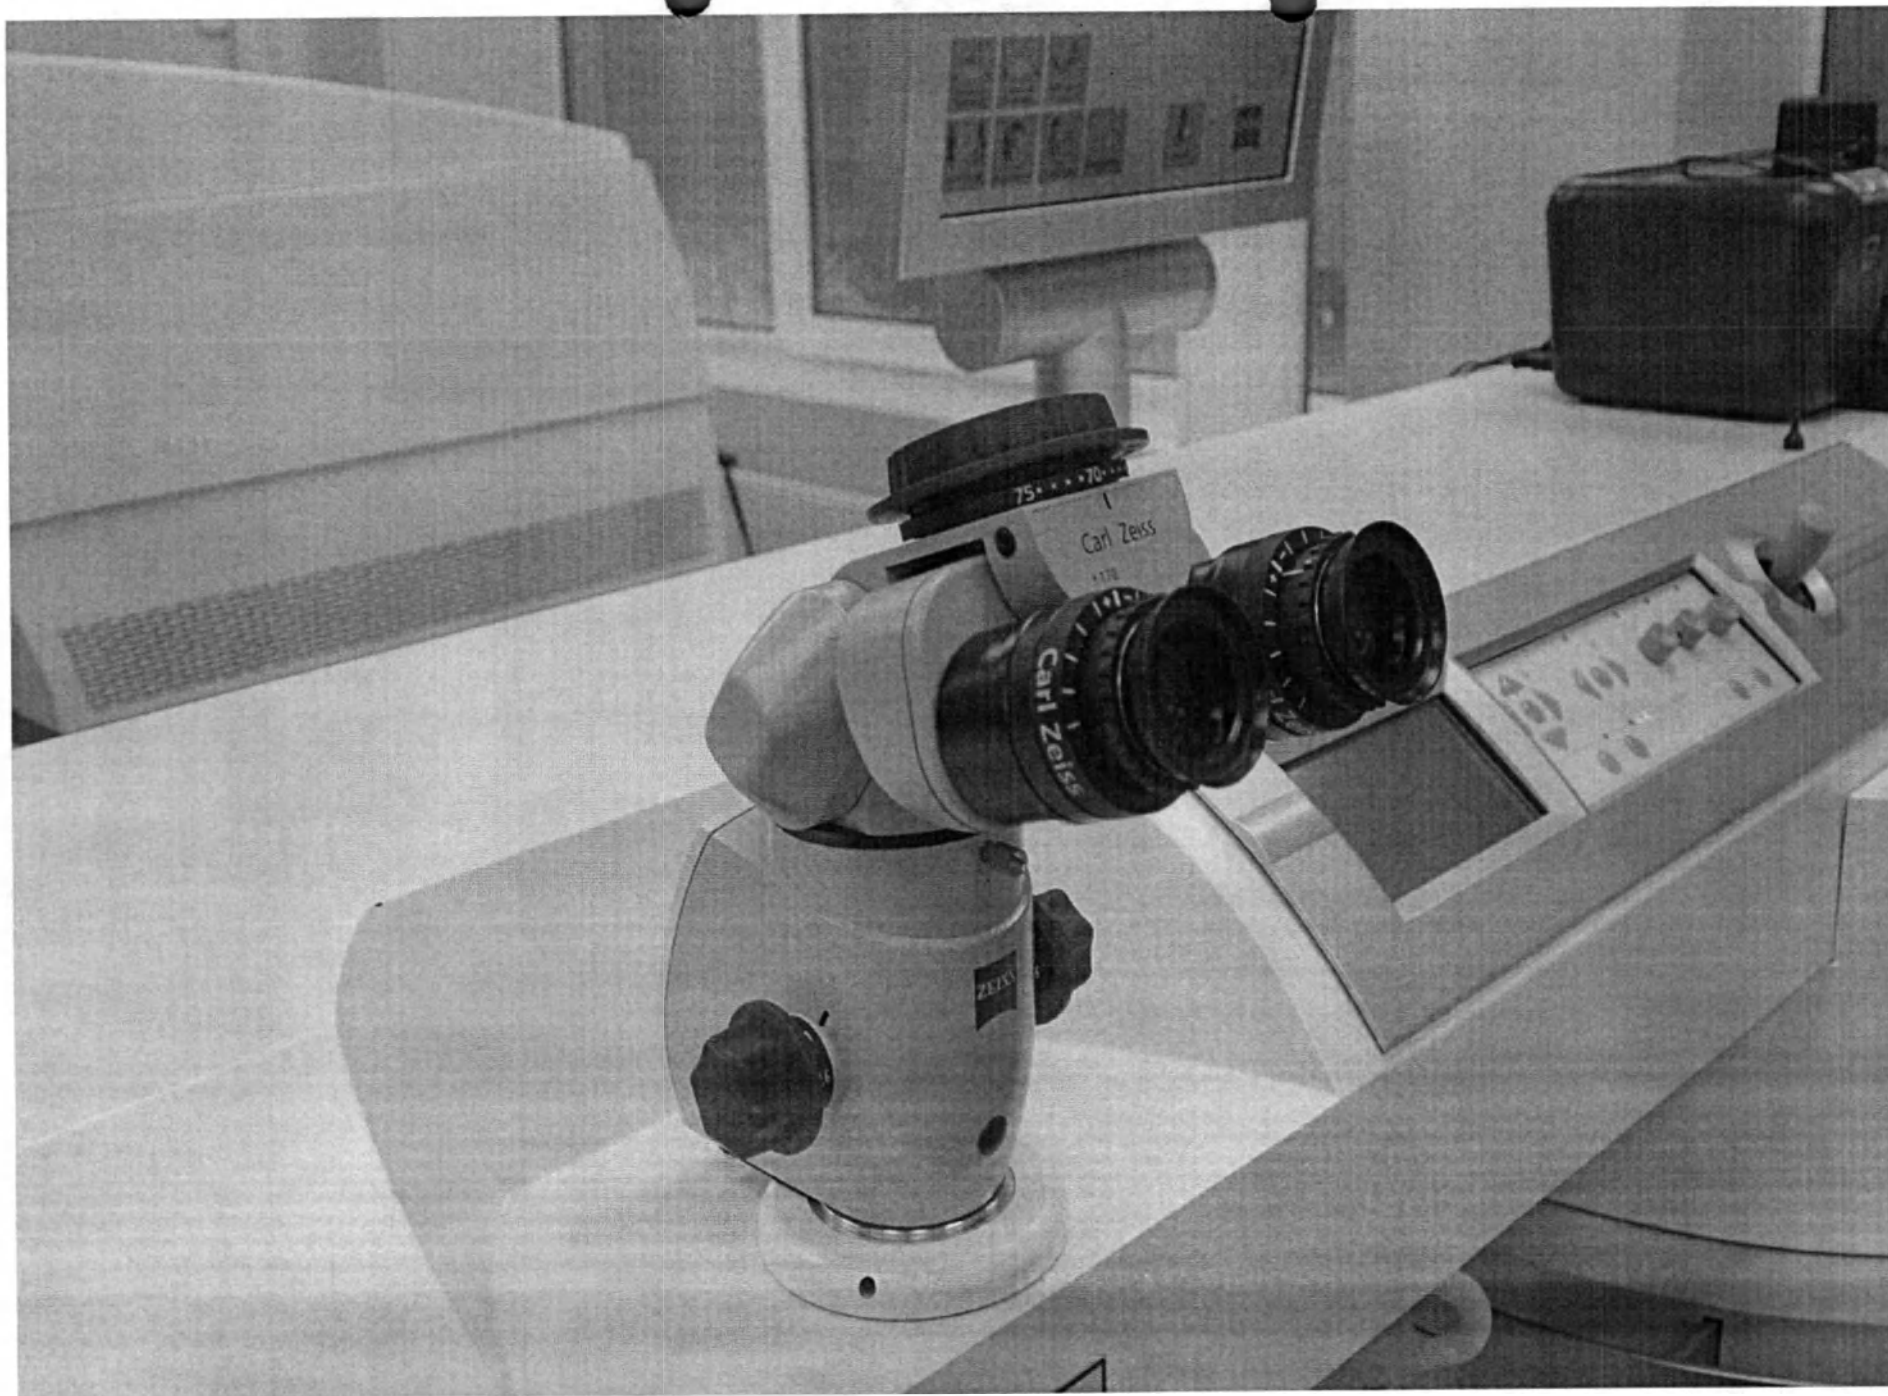


Колпачки асептические (не более 6 уп.).

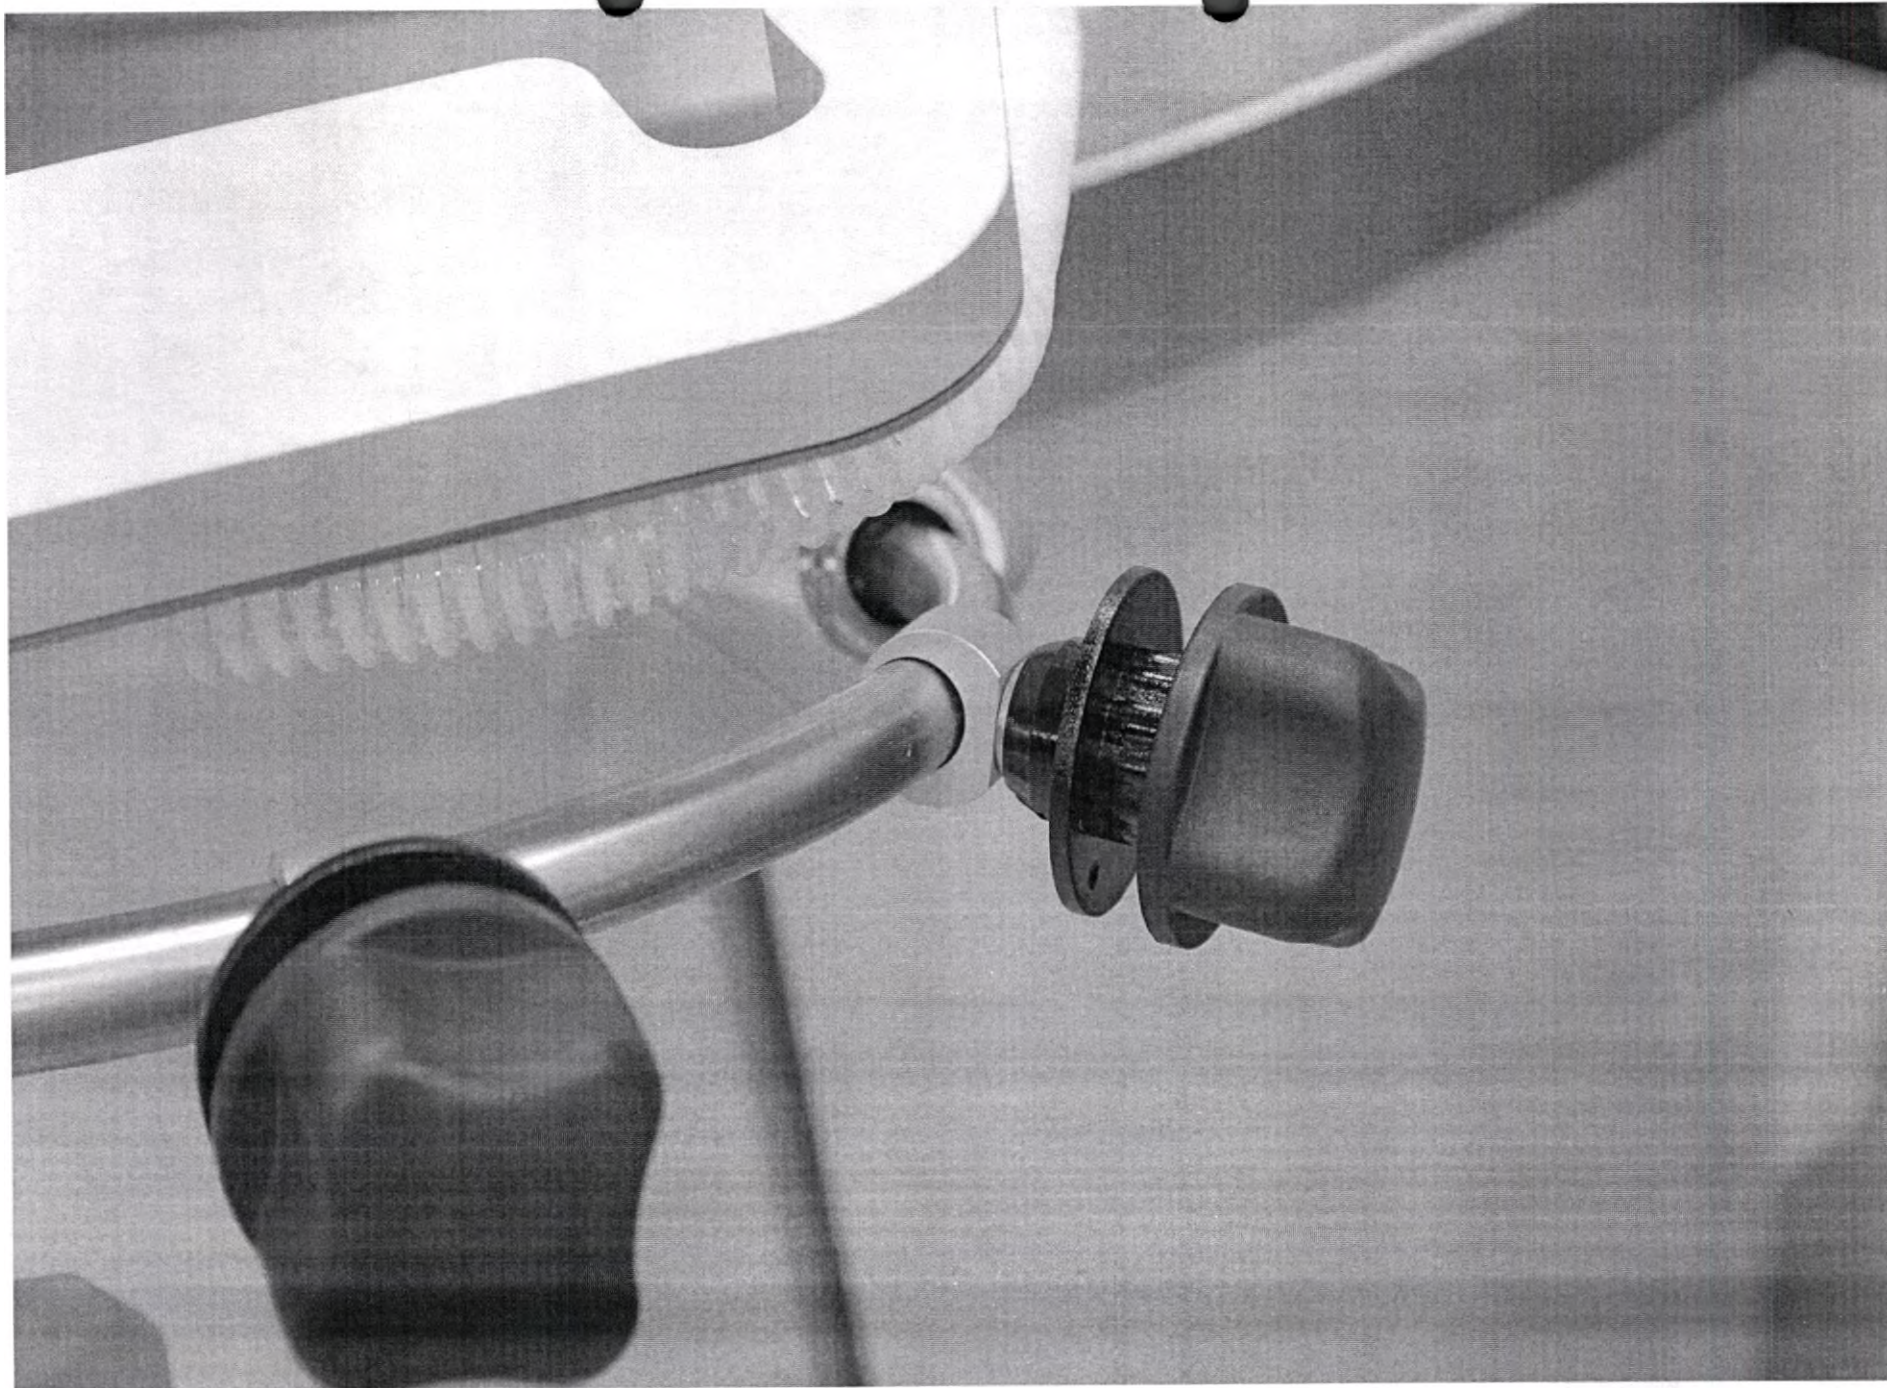

Колпачок защитный для лампы щелевой ручной (не более 6 шт.).

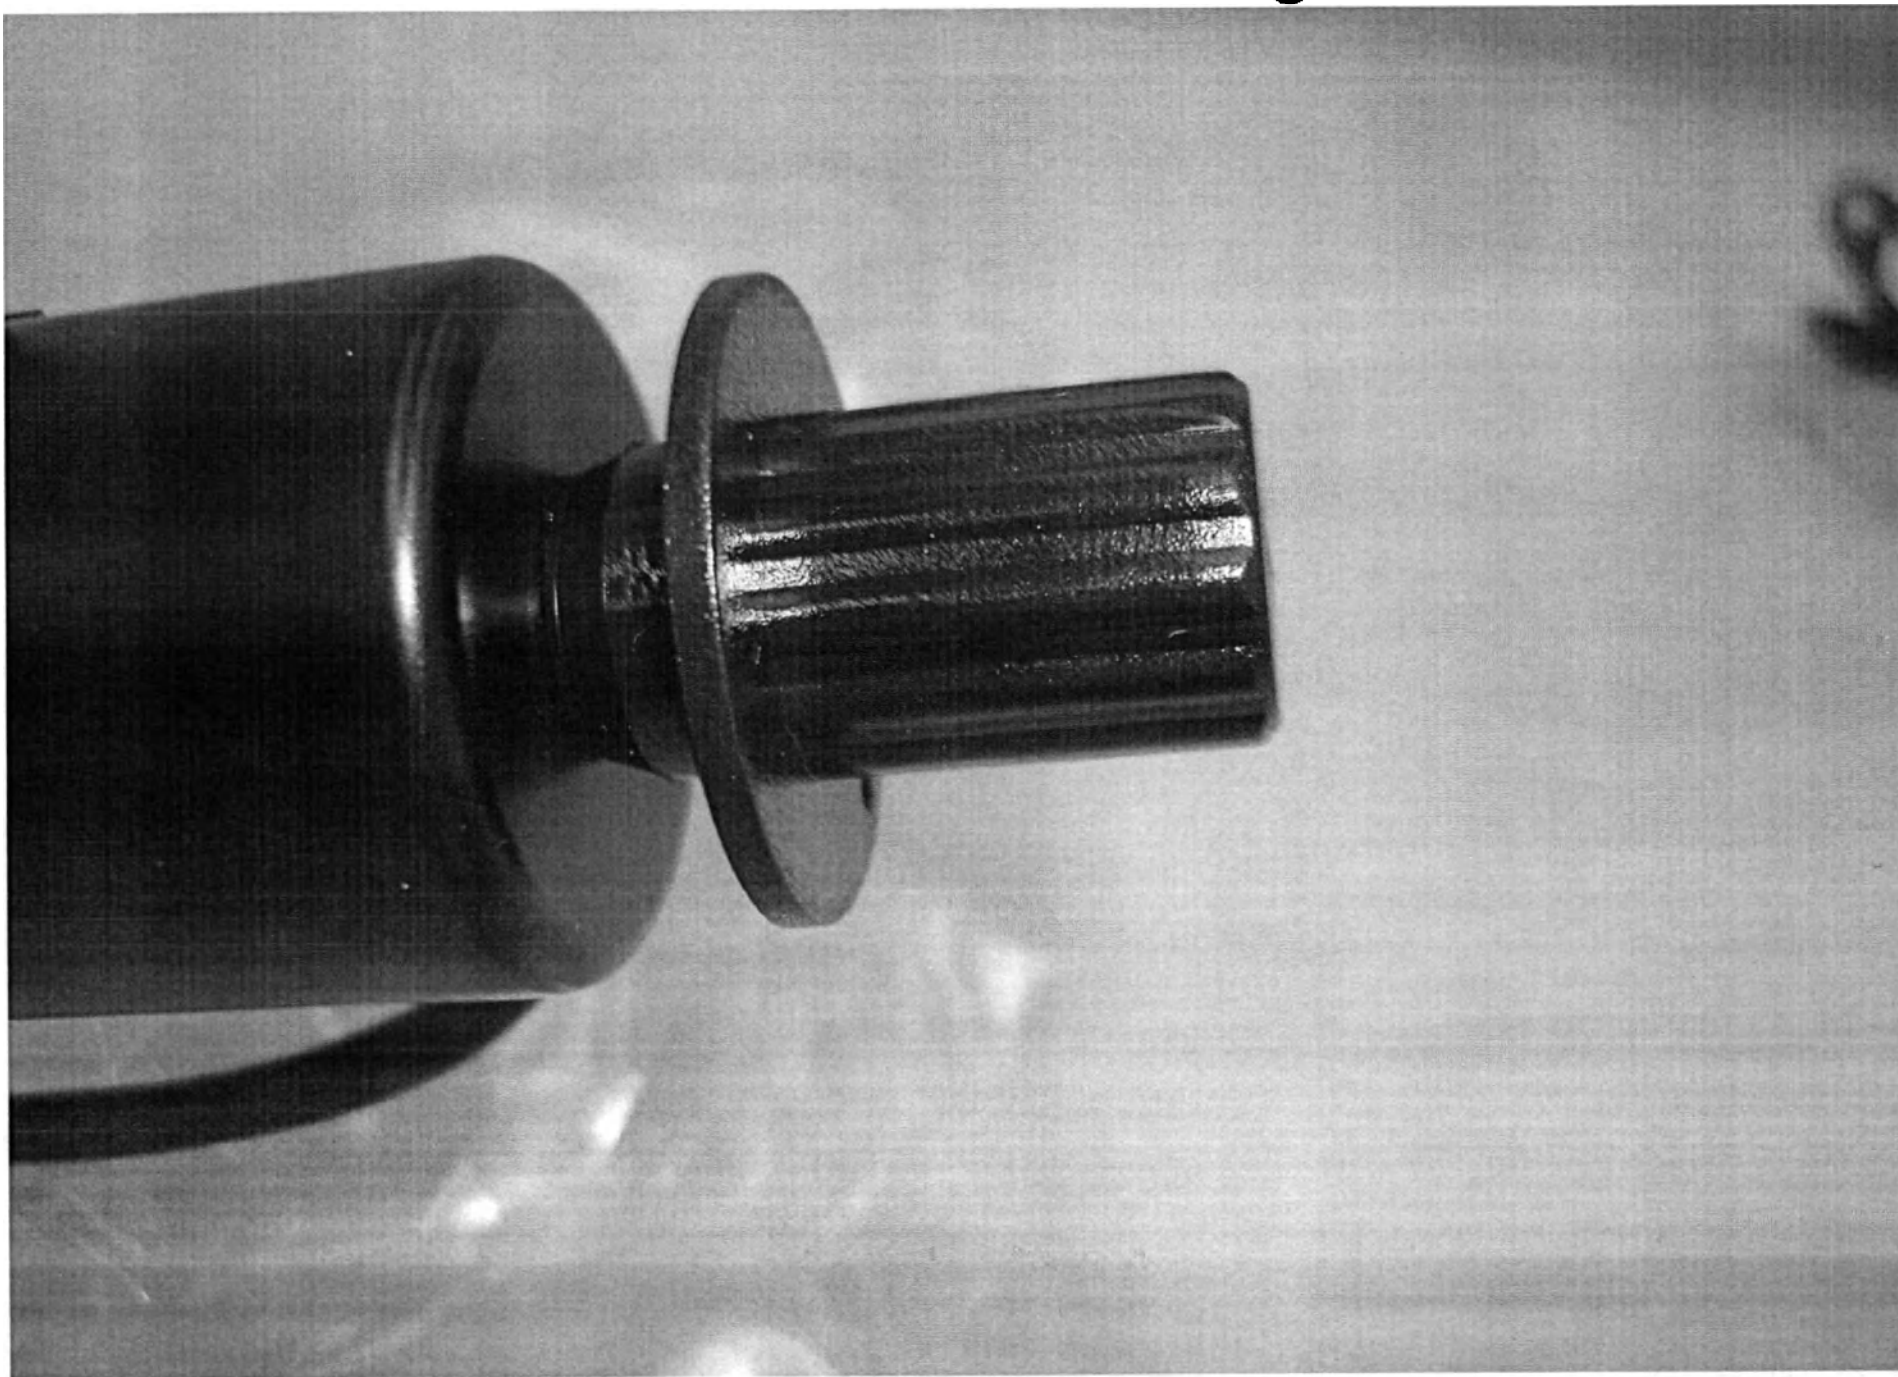

Комплект магнитов для подставки для теста флюенса (не более 2 уп.).

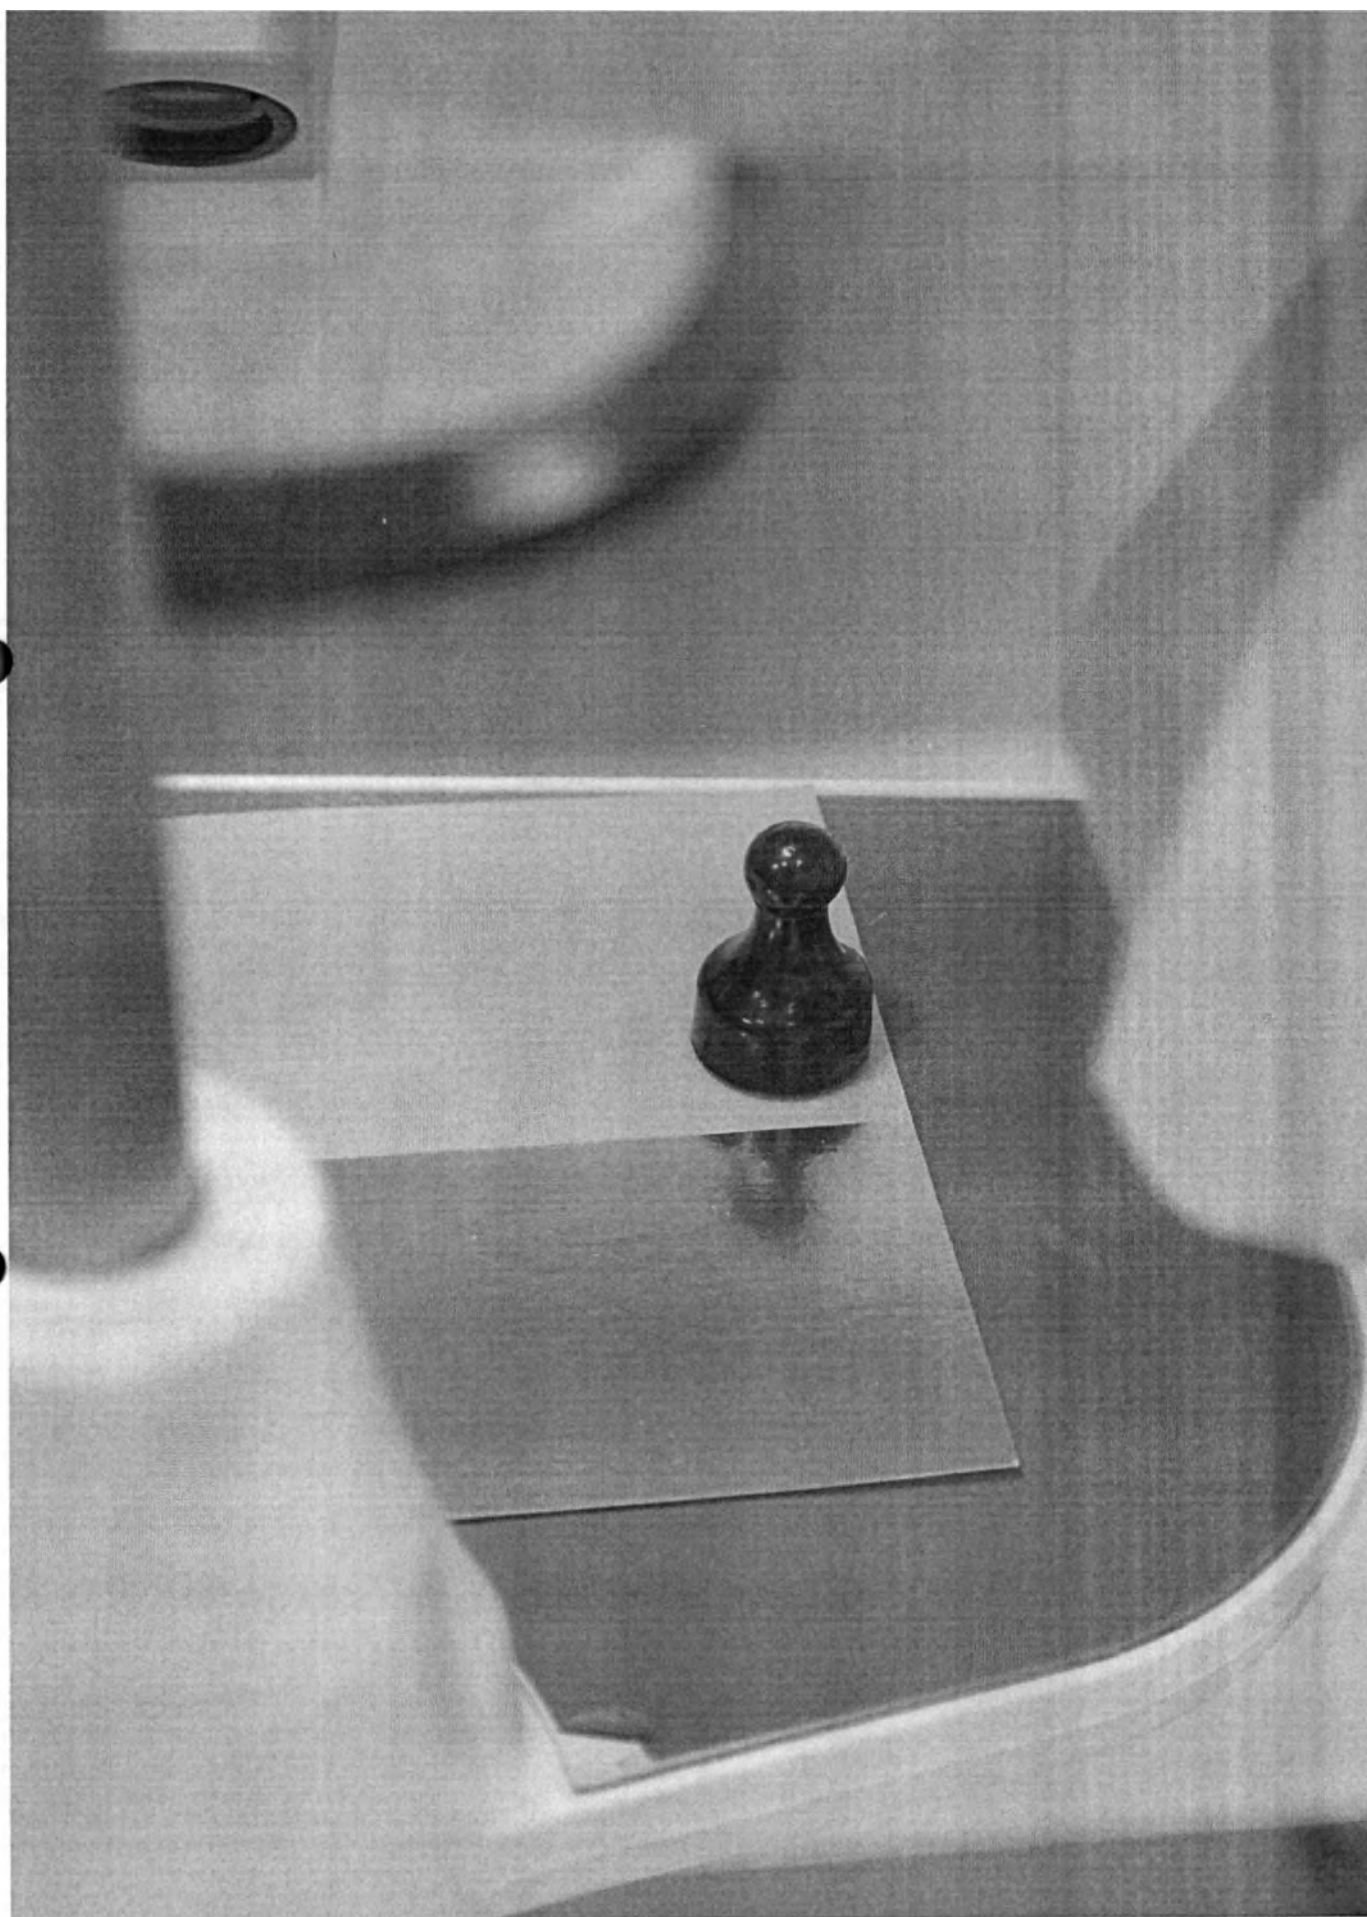

Комплект фильтров и шлангов (не более 6 уп.).



Лампа галогенная для лампы щелевой ручной (не более 3 шт.).



Carl Zeiss Meditec AG, 07740 Jena, GERMANY
Halogenlampe 12V/30W/PG22(+)


[Halogen Lamp 12V/30W/PG22(+)]

Country of Origin : GERMANY


000000-0120-704




Педаль ножная.

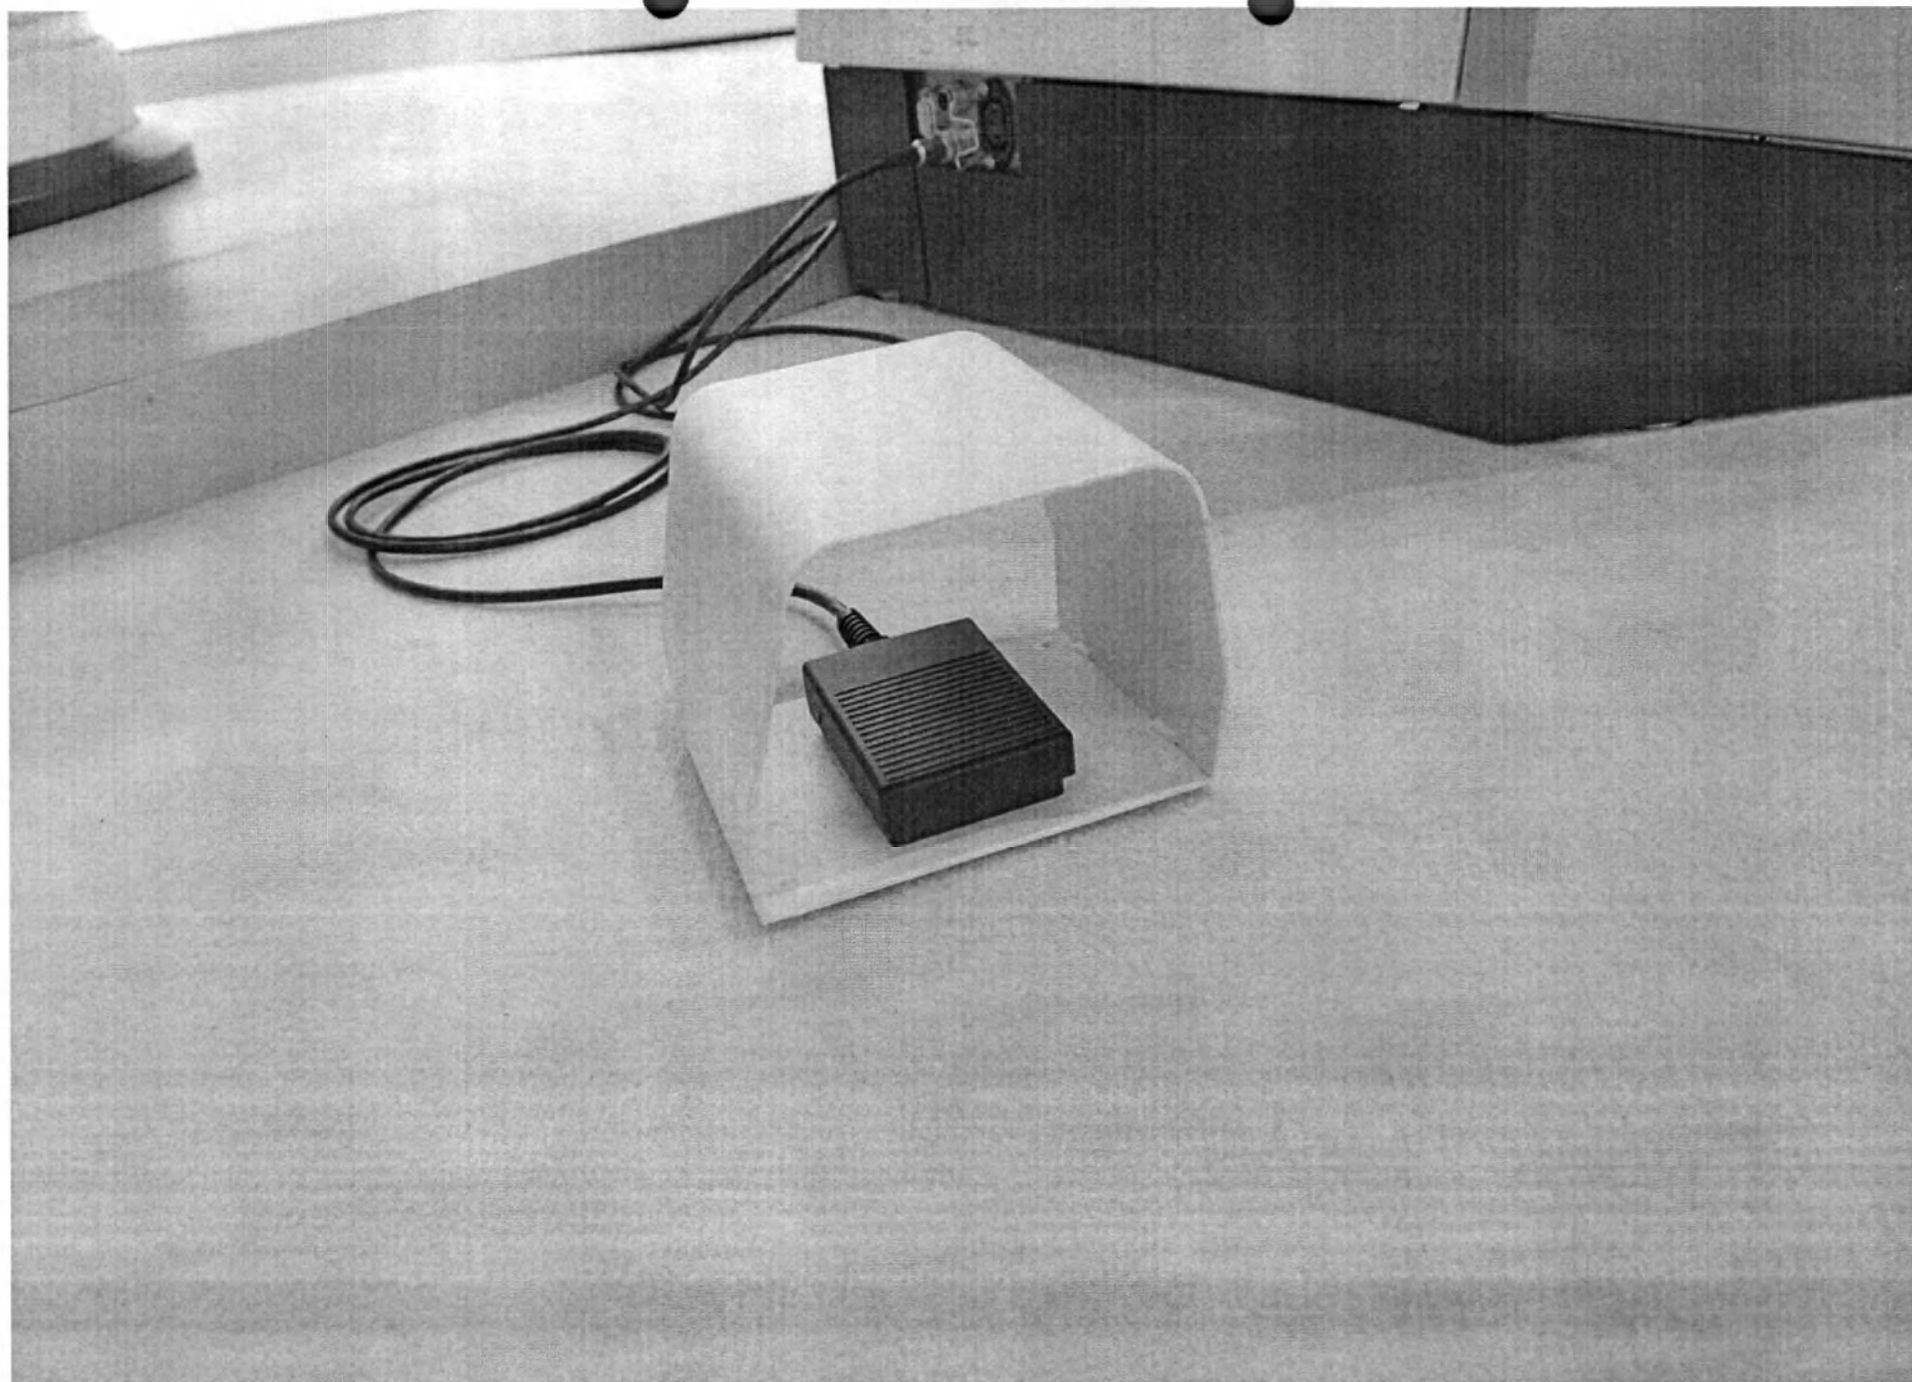

Тест-бумага флюенса (не более 5 уп.).

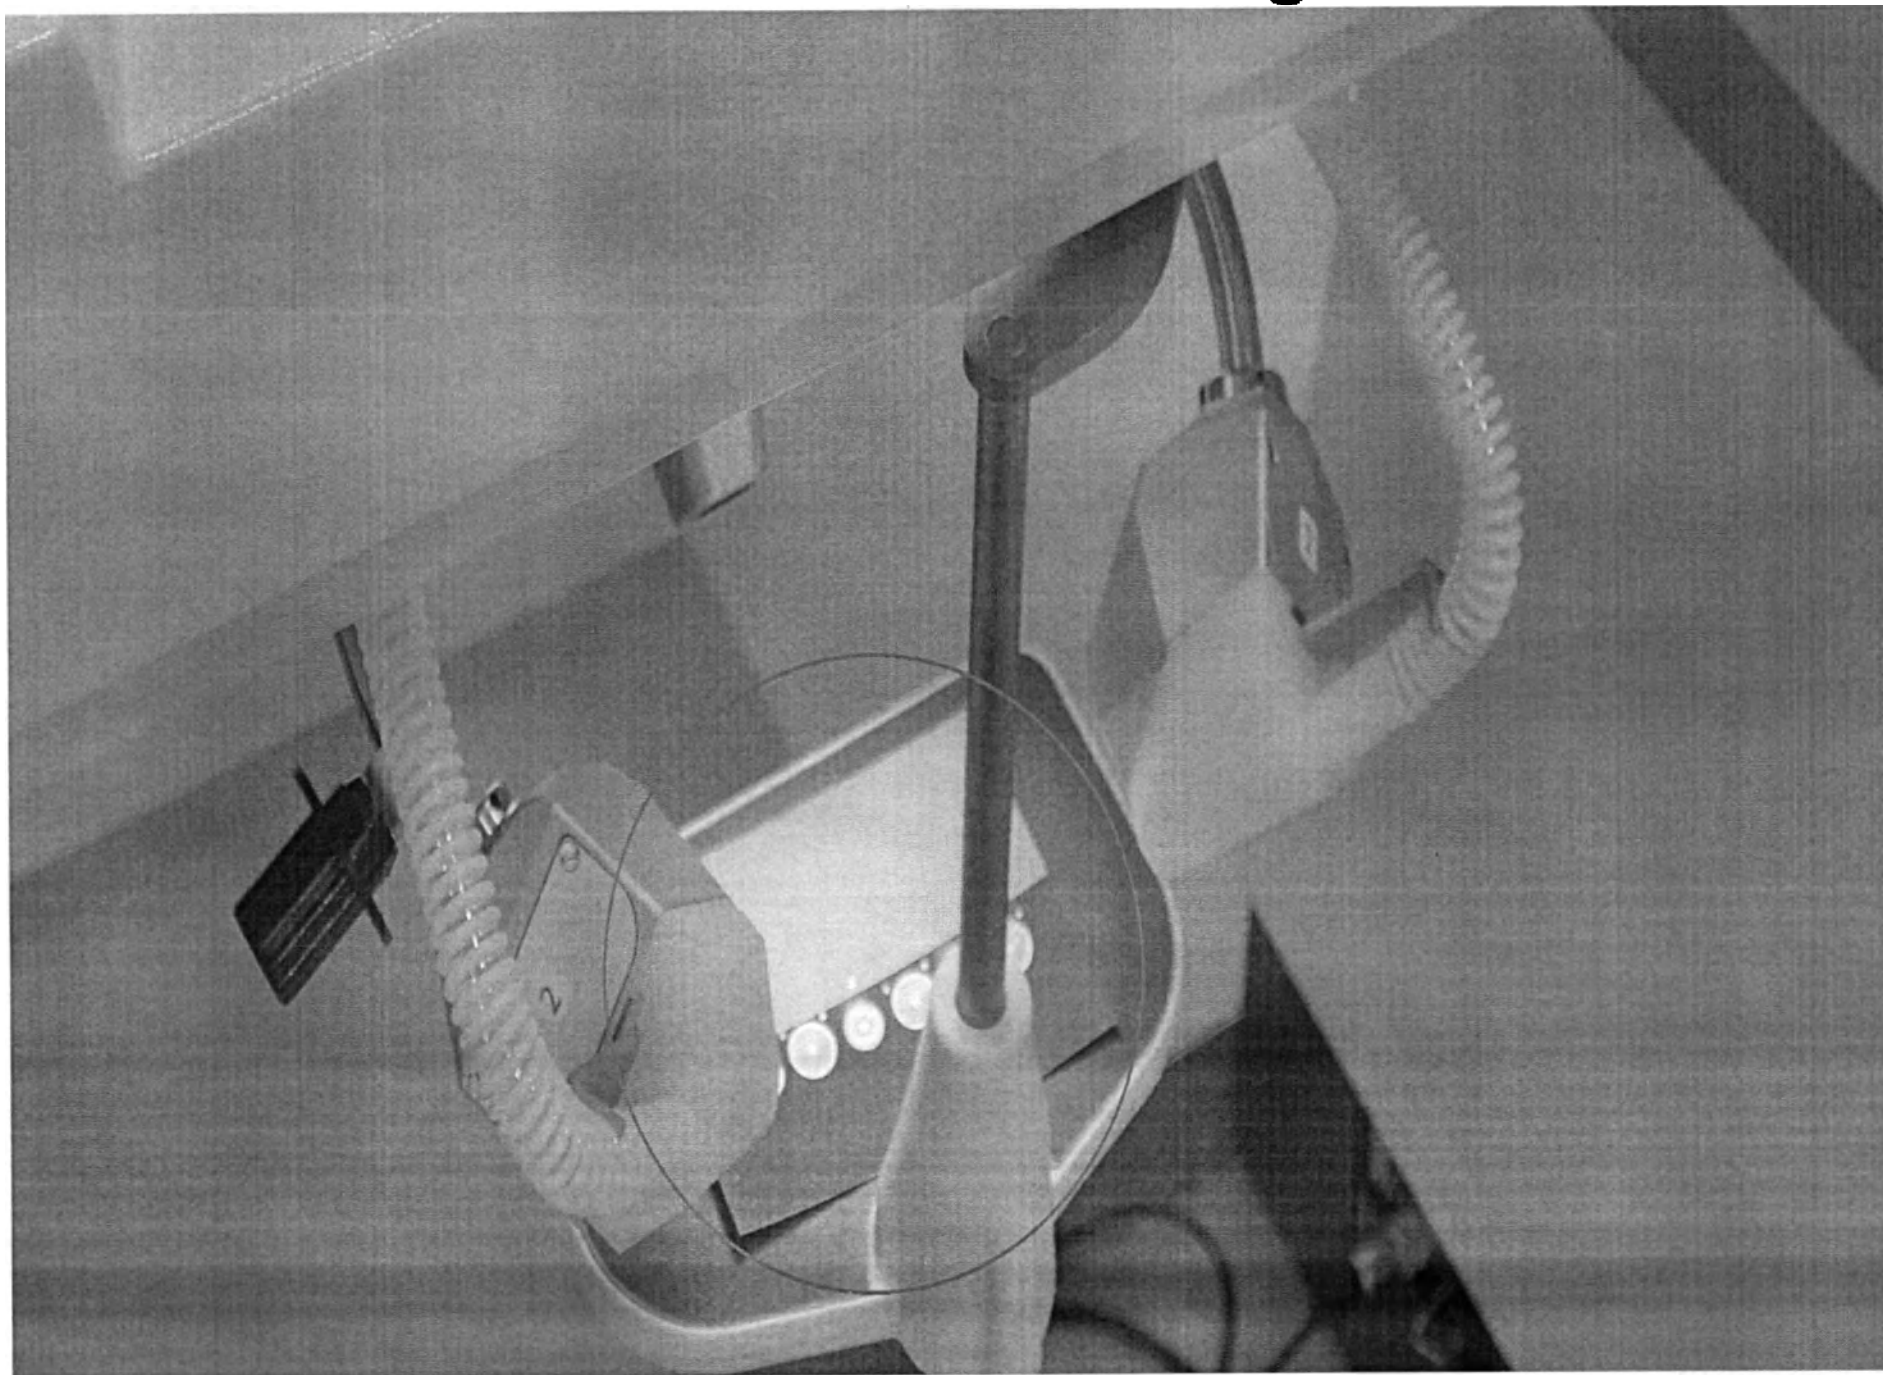



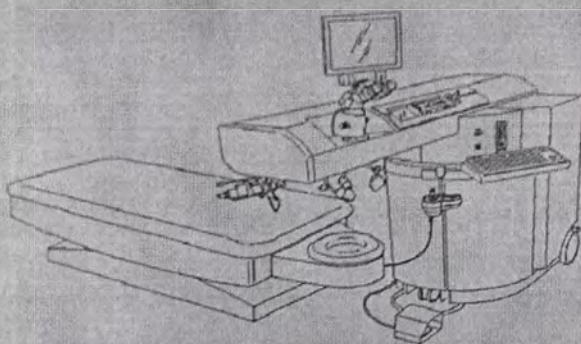

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Система лазерная офтальмологическая
экимерная MEL 80, с принадлежностями.

Carl Zeiss Meditec AG

Carl Zeiss Meditec AG

Goeschwitzer Str. 51-52

07745 Jena

Dr. Franziska Erxleben


Phone +49 38 41 20 621 RA

Fax +49 36 41/220 674



Руководство по эксплуатации

Система лазерная офтальмологическая эксимерная MEL 90, с принадлежностями.

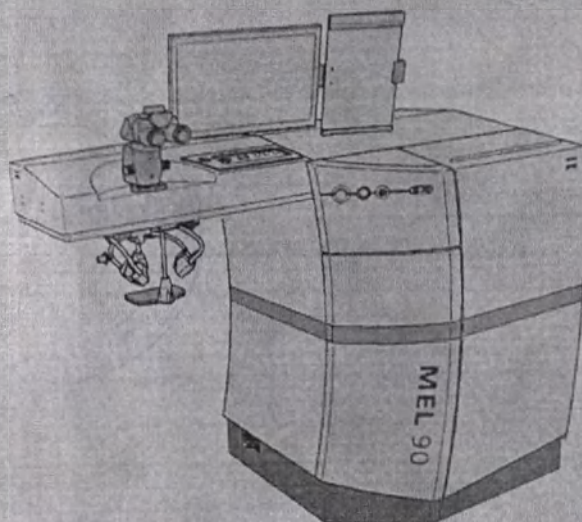

Carl Zeiss Meditec AG
i.V.

Carl Zeiss Meditec AG
Goeschwilzer Str. 54-58
07745 Dr. Franziska Erxleben
Phone +49 36 41/220 1 Team Leader RA
Fax +49 36 41/220 678

Всего пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью 38 лист об



М.С. Игельник