

Руководитель направления по регистрации
продукции для диагностической визуализации,
высокотехнологичной терапии и ультразвуковой диагностики




ООО «Сименс Здравоохранение»

 Е. С. Тисленко


«15» июня 2022 г.

**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**


**«Система рентгенодиагностическая Luminos dRF Max в исполнениях с
принадлежностями»**

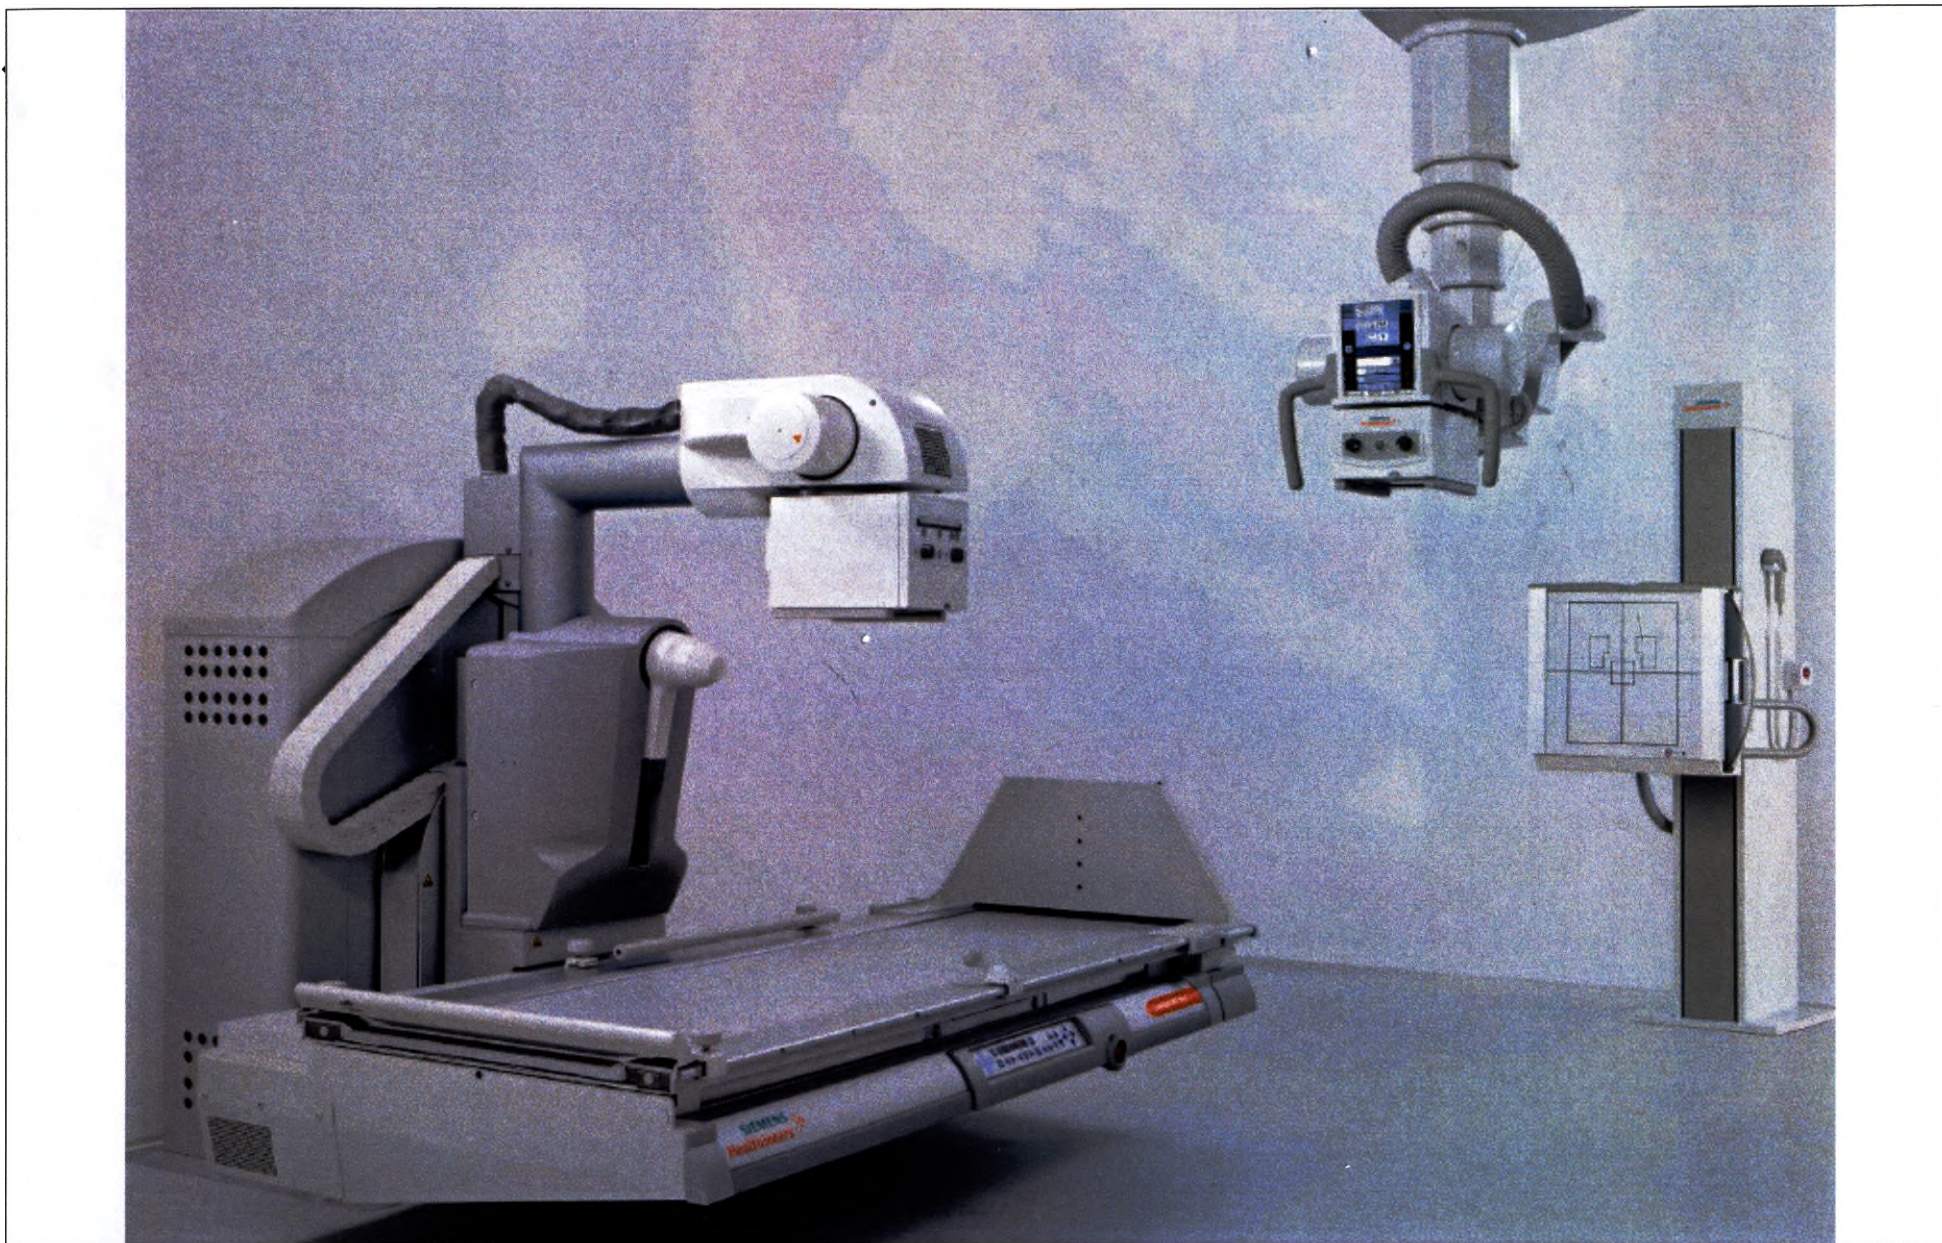


Общий вид медицинского изделия «Система рентгенодиагностическая Luminos dRF Max в исполнении с принадлежностями»

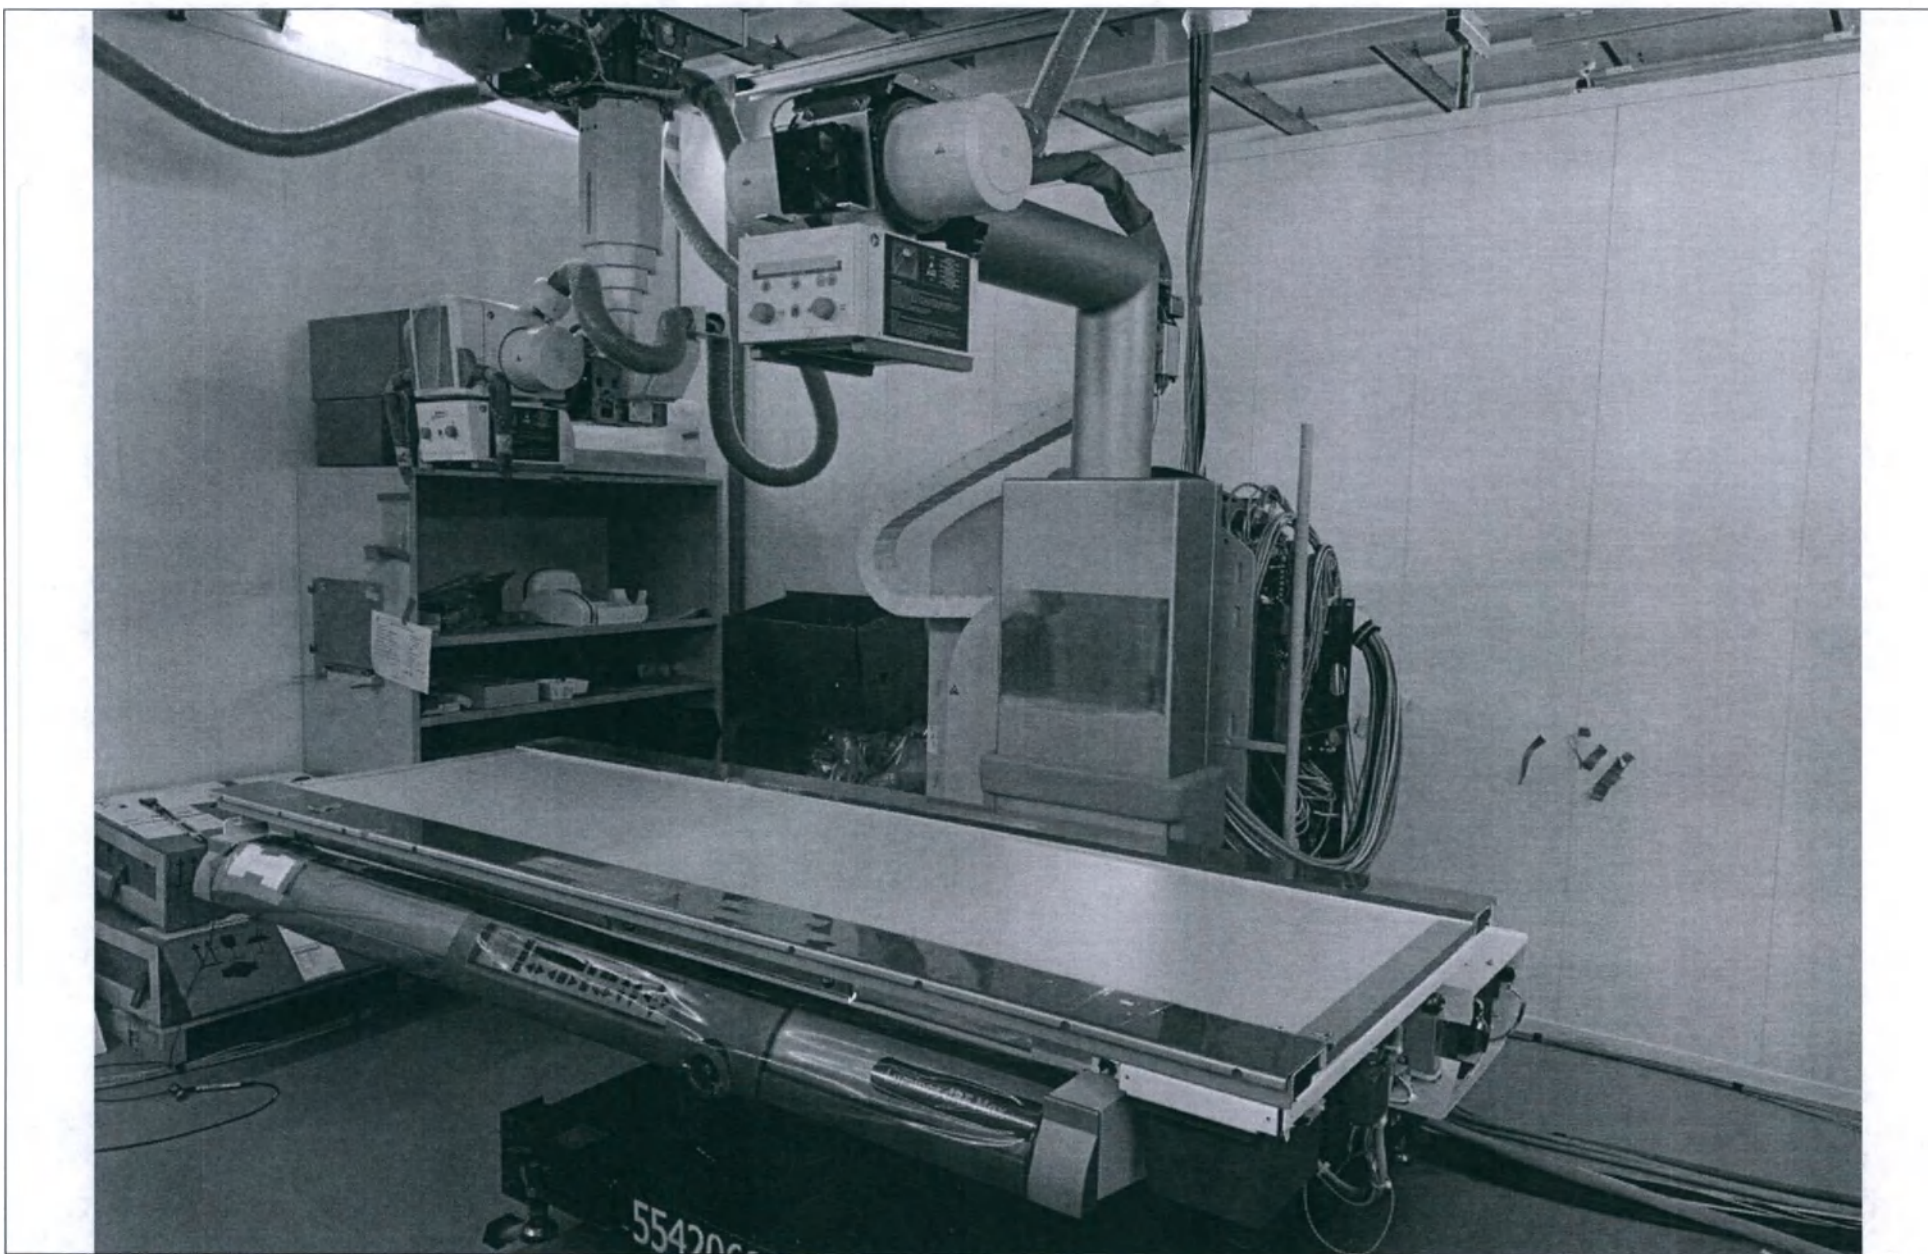


1. Базовый блок, вариант 1
1. Телеуправляемый стол-штатив Luminos dRF Max

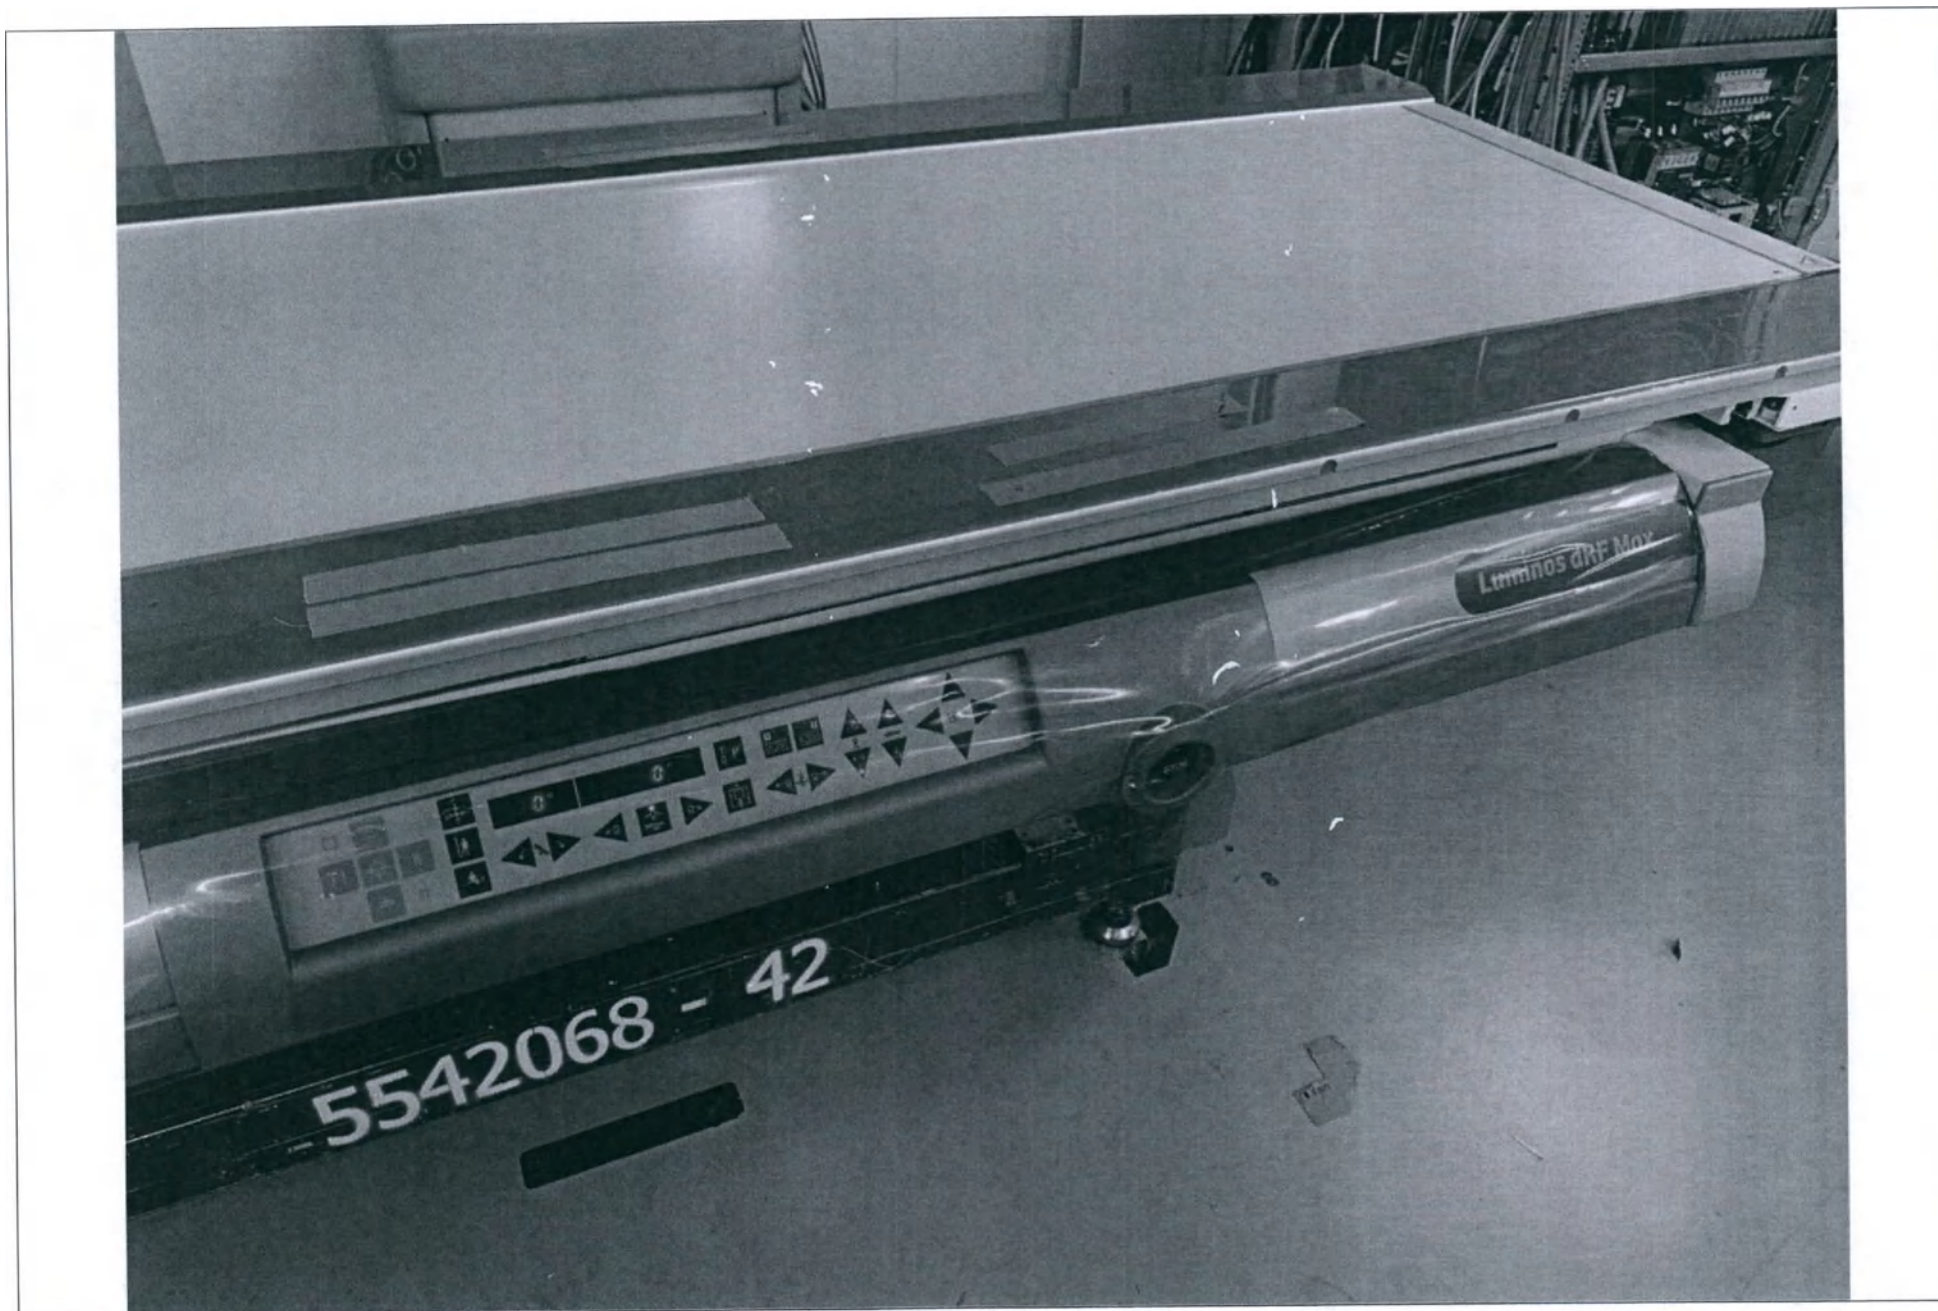


2.1 Плоский детектор.

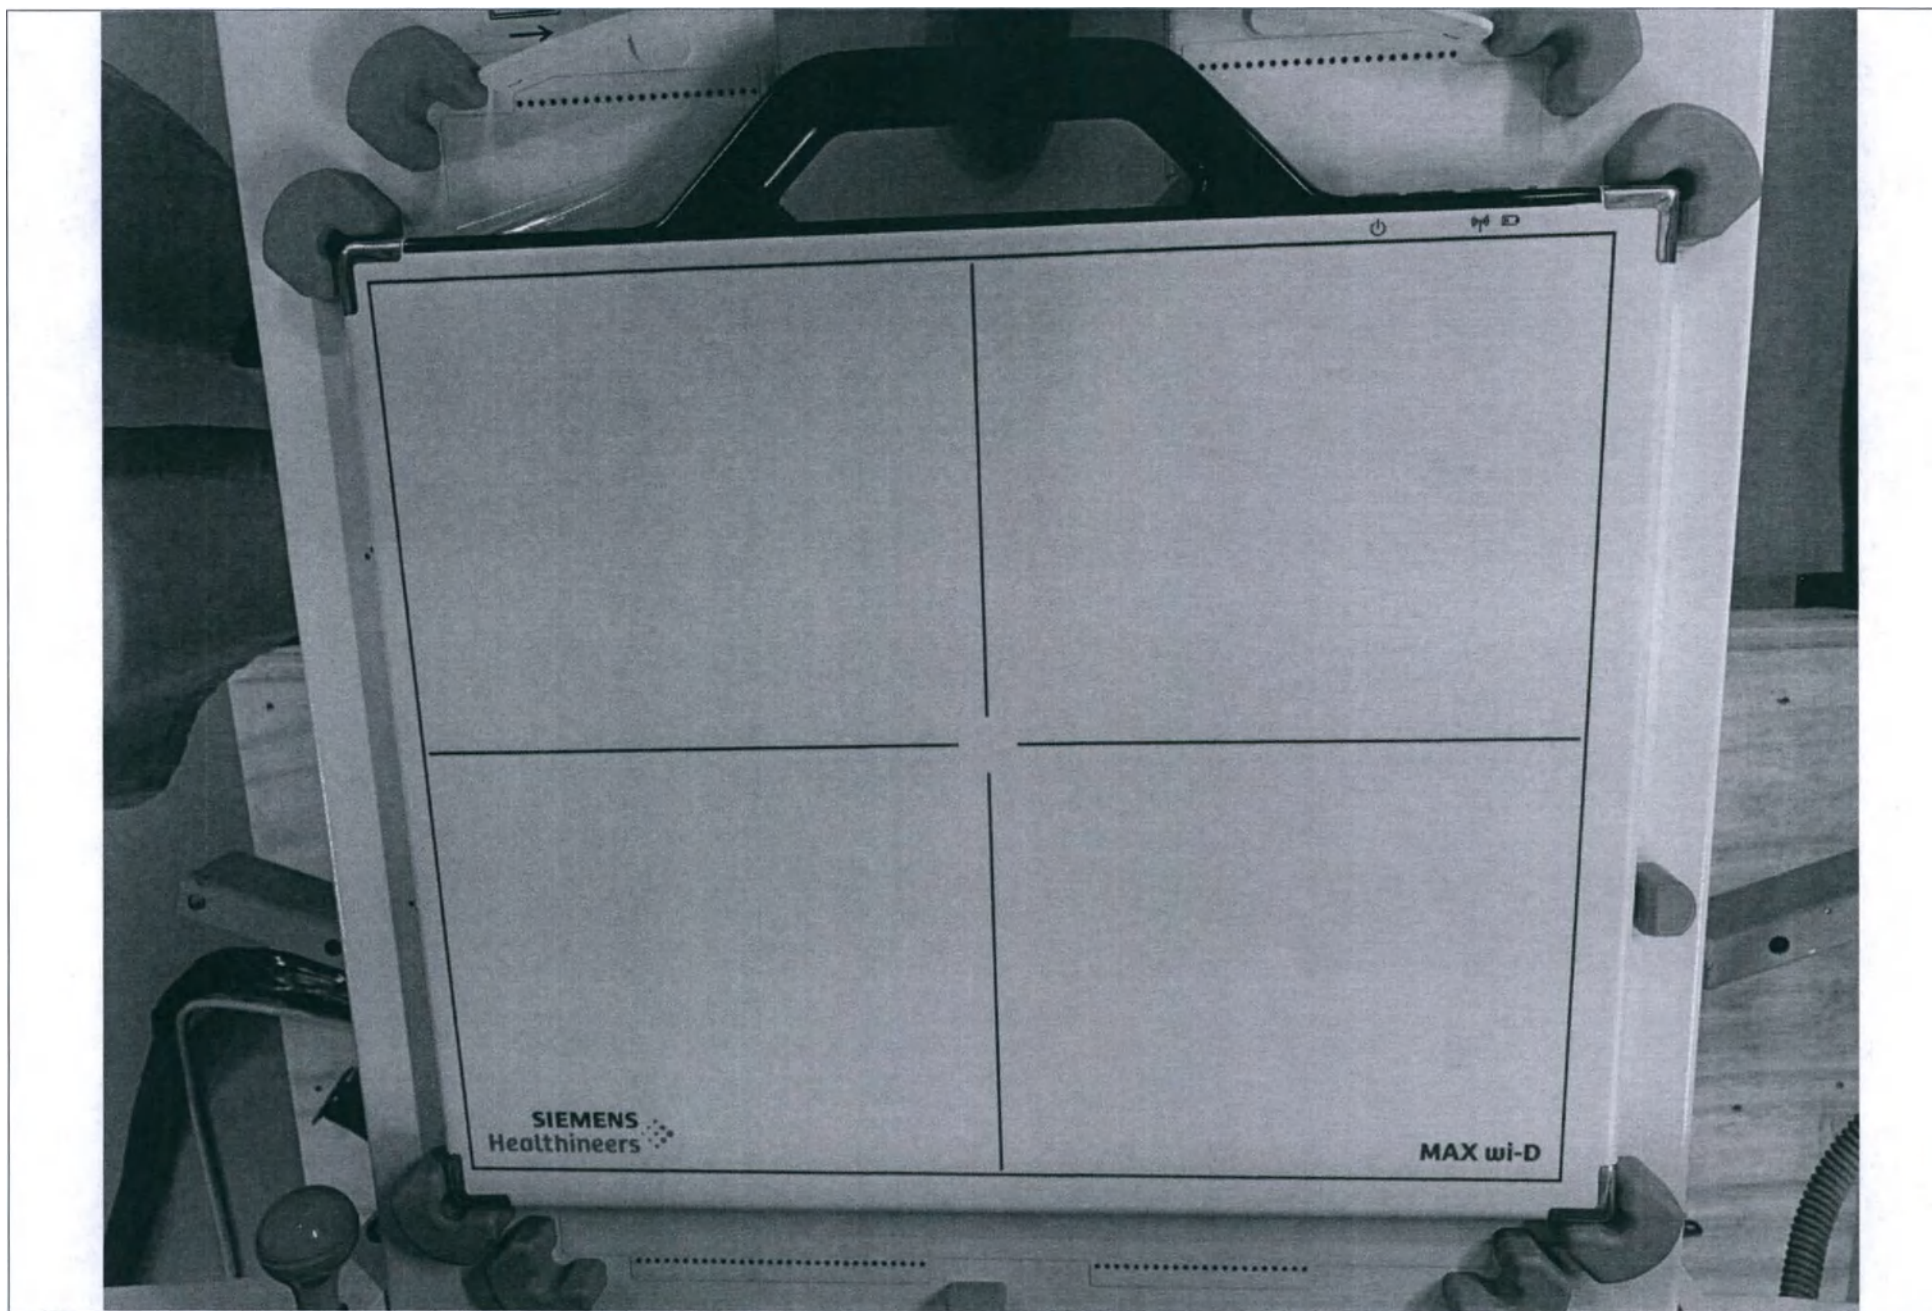


2.2 Беспроводной детектор MAX wi-D.

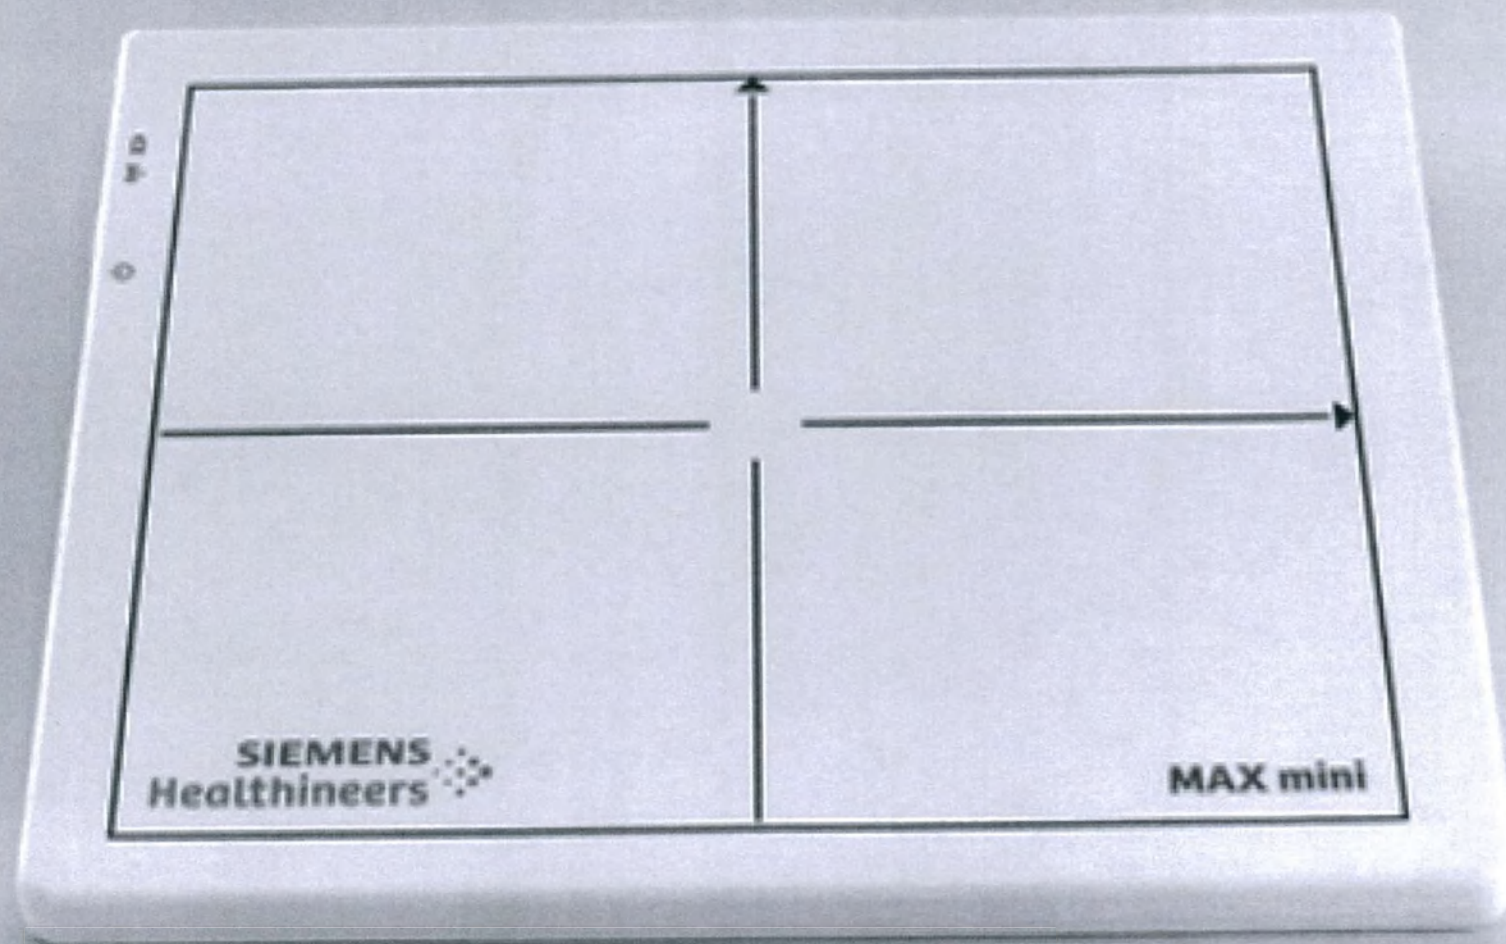


2.3. Беспроводной детектор MAX mini.

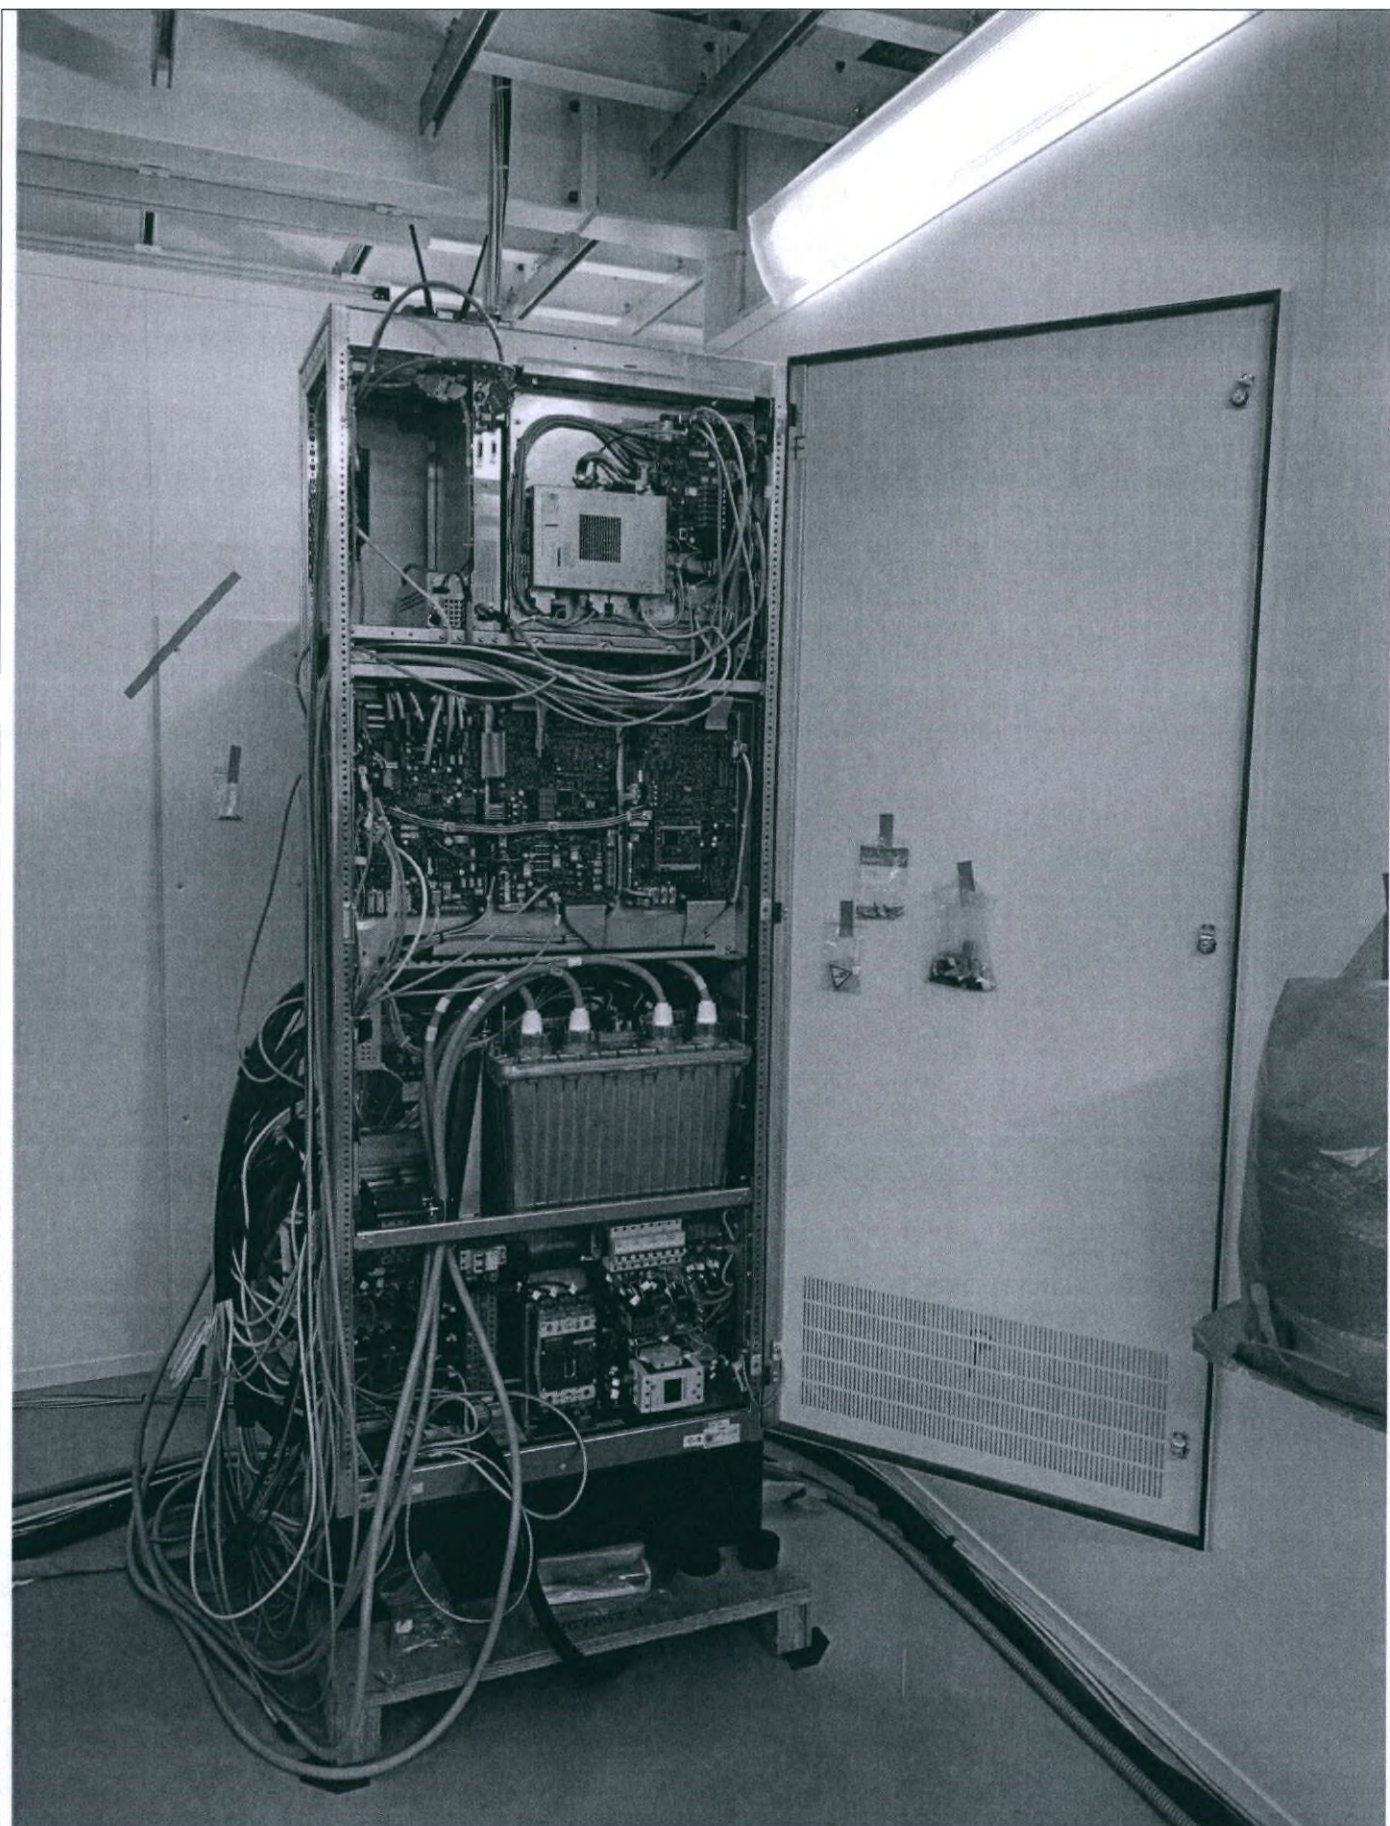


3. Генератор рентгеновский POLYDOROS F, варианты исполнения 65 кВт, 80 кВт

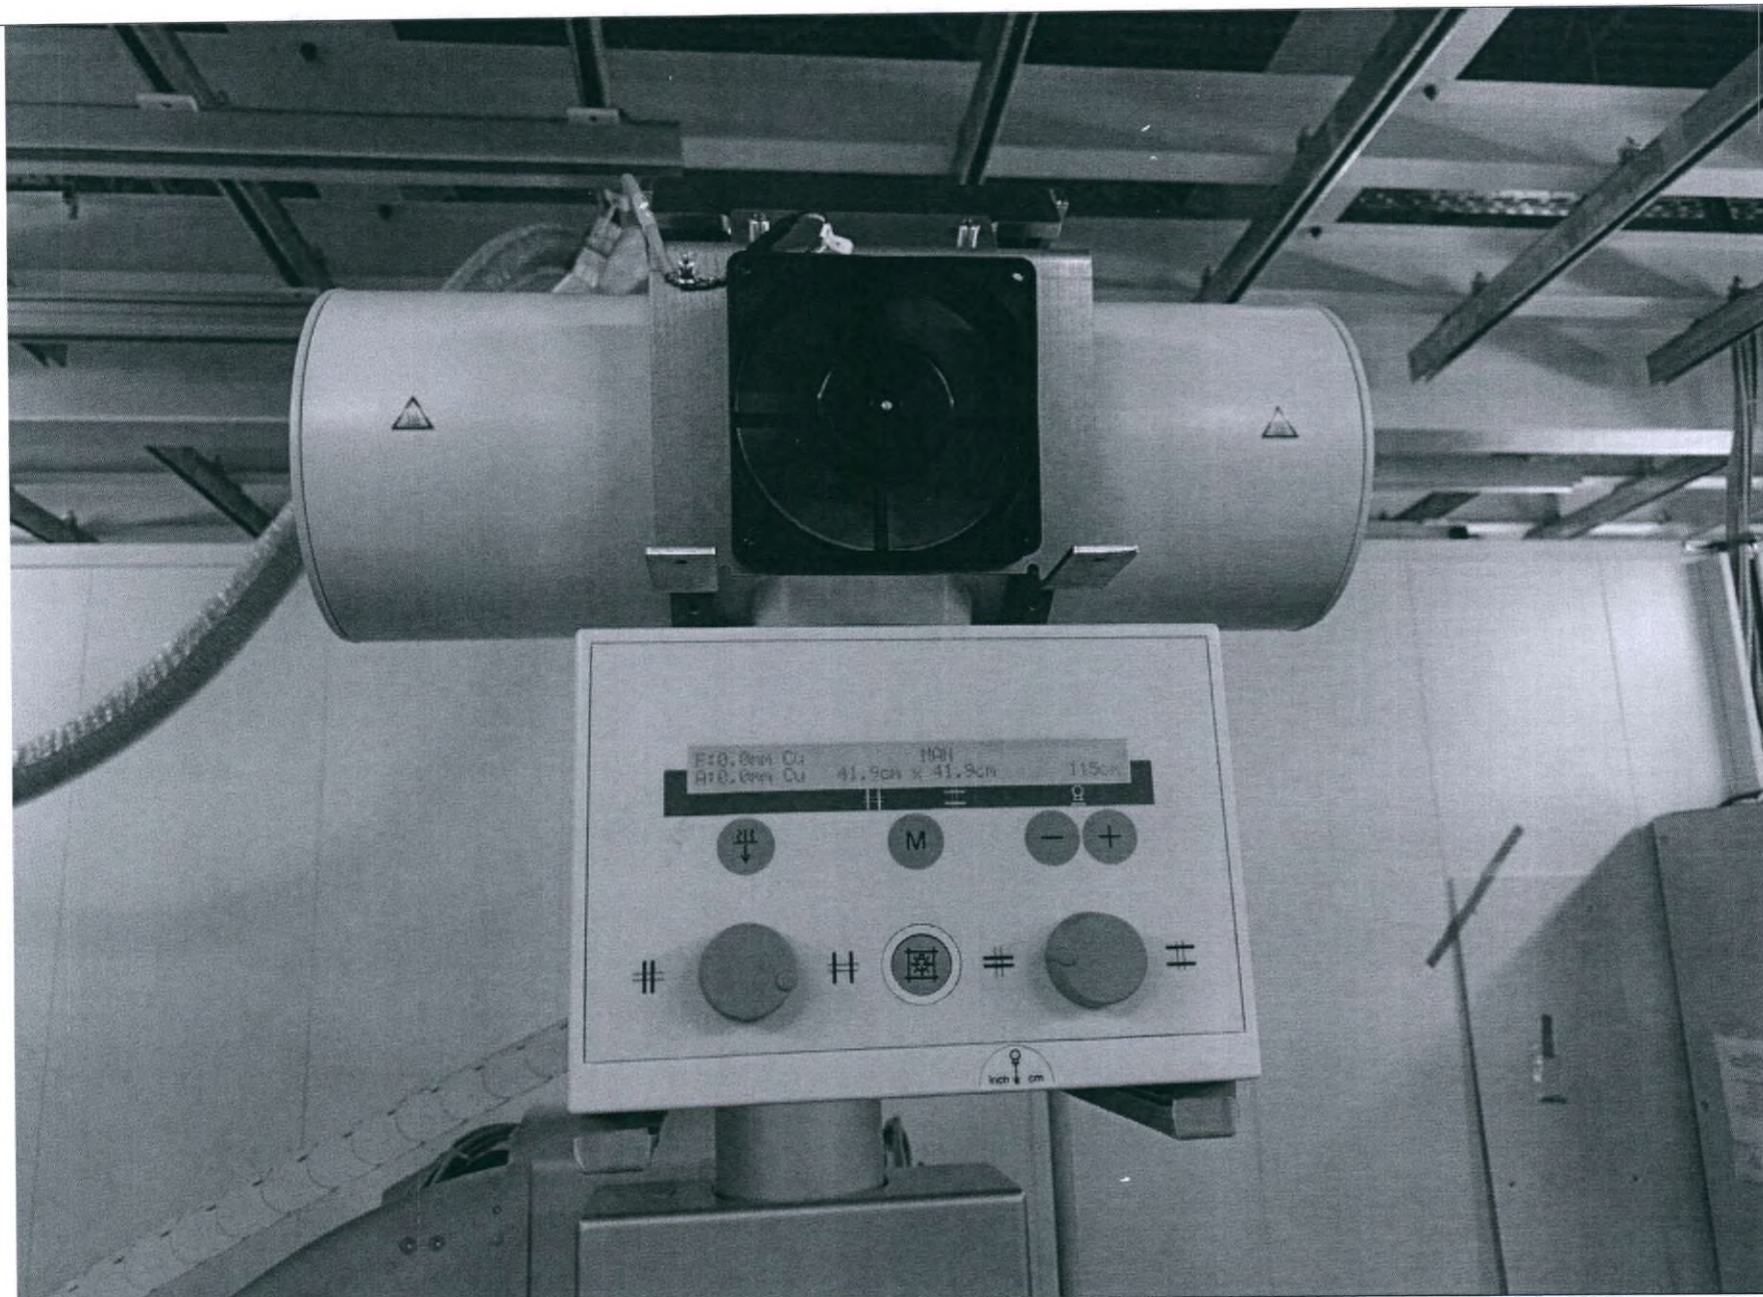


4. Рентгеновская трубка ОПТИПОР

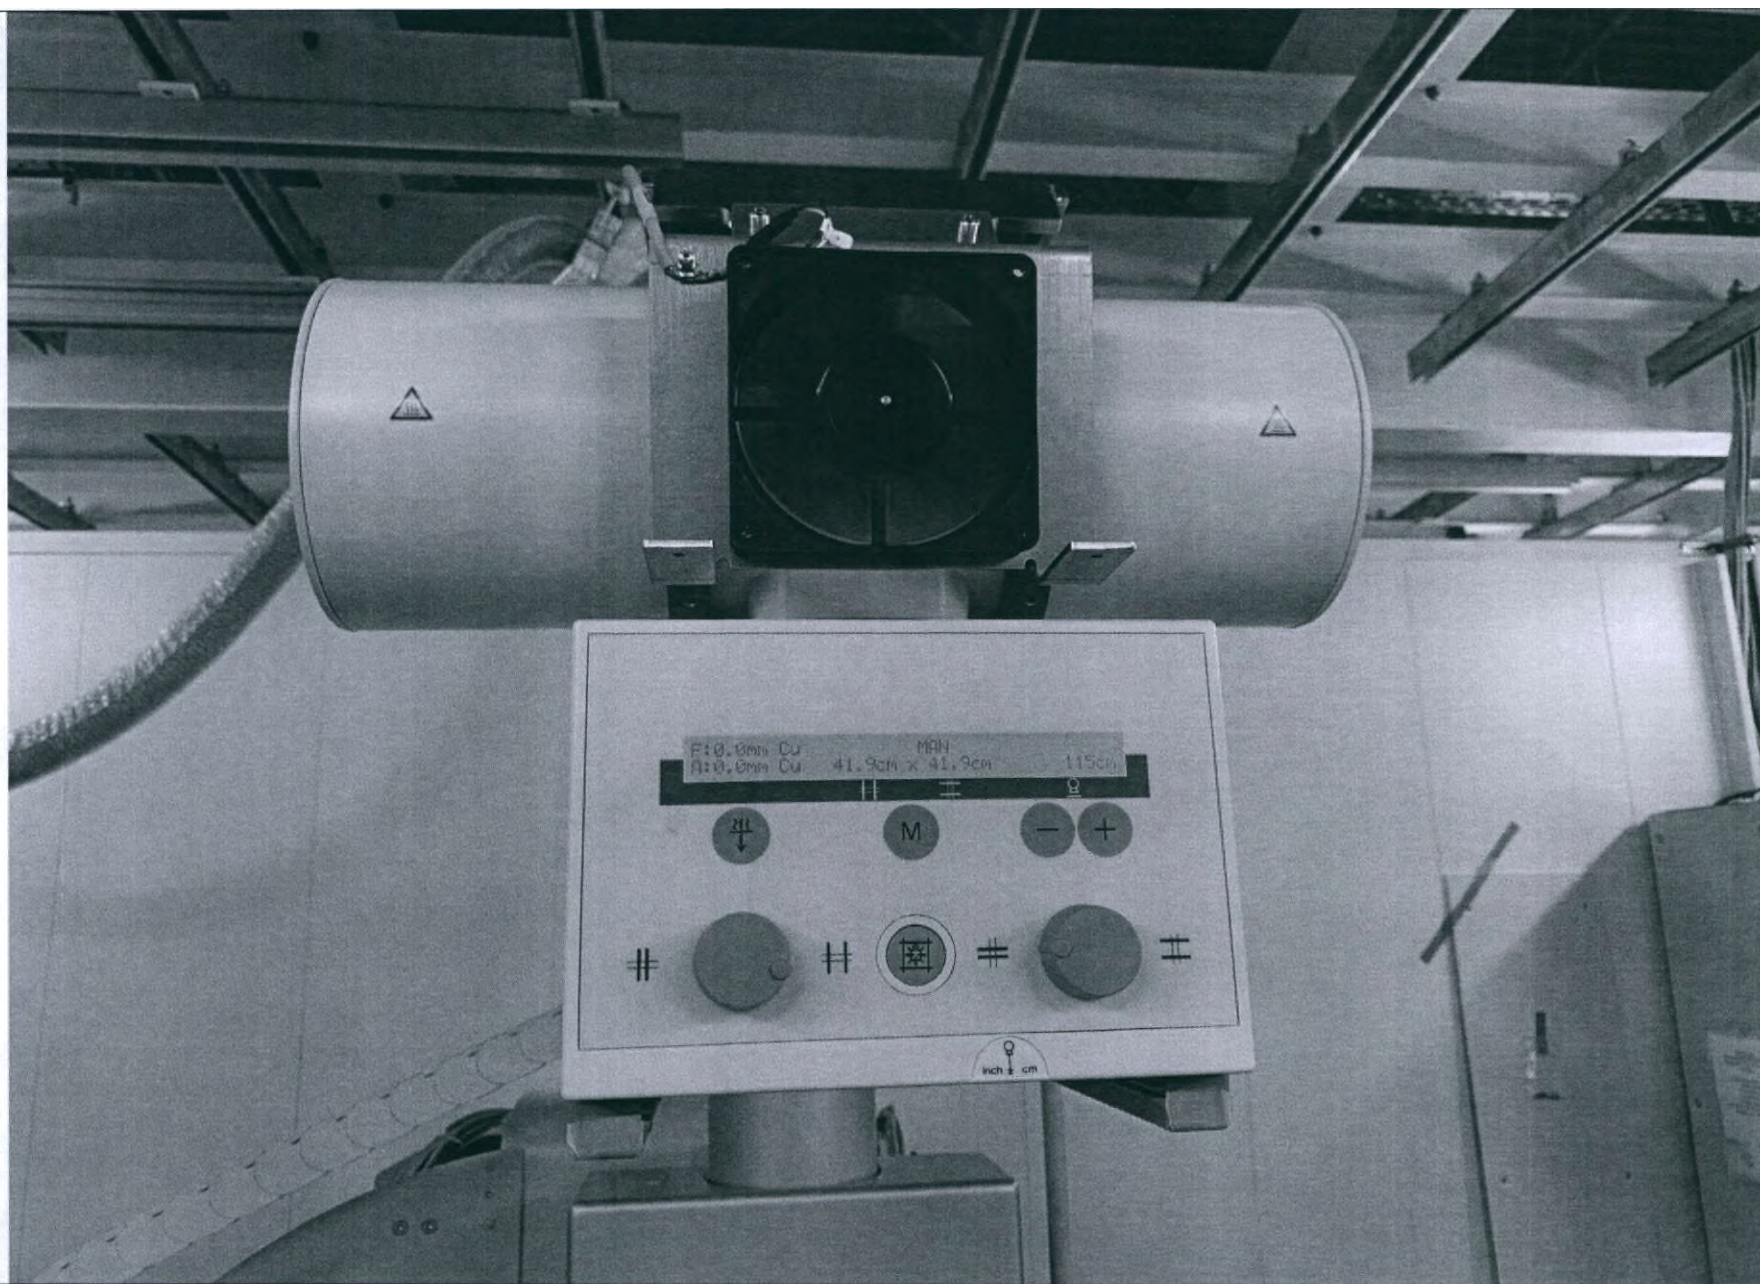

5. Многоплестковый коллиматор, варианты исполнения: -стандартный; -с полупрозрачными фильтрами.

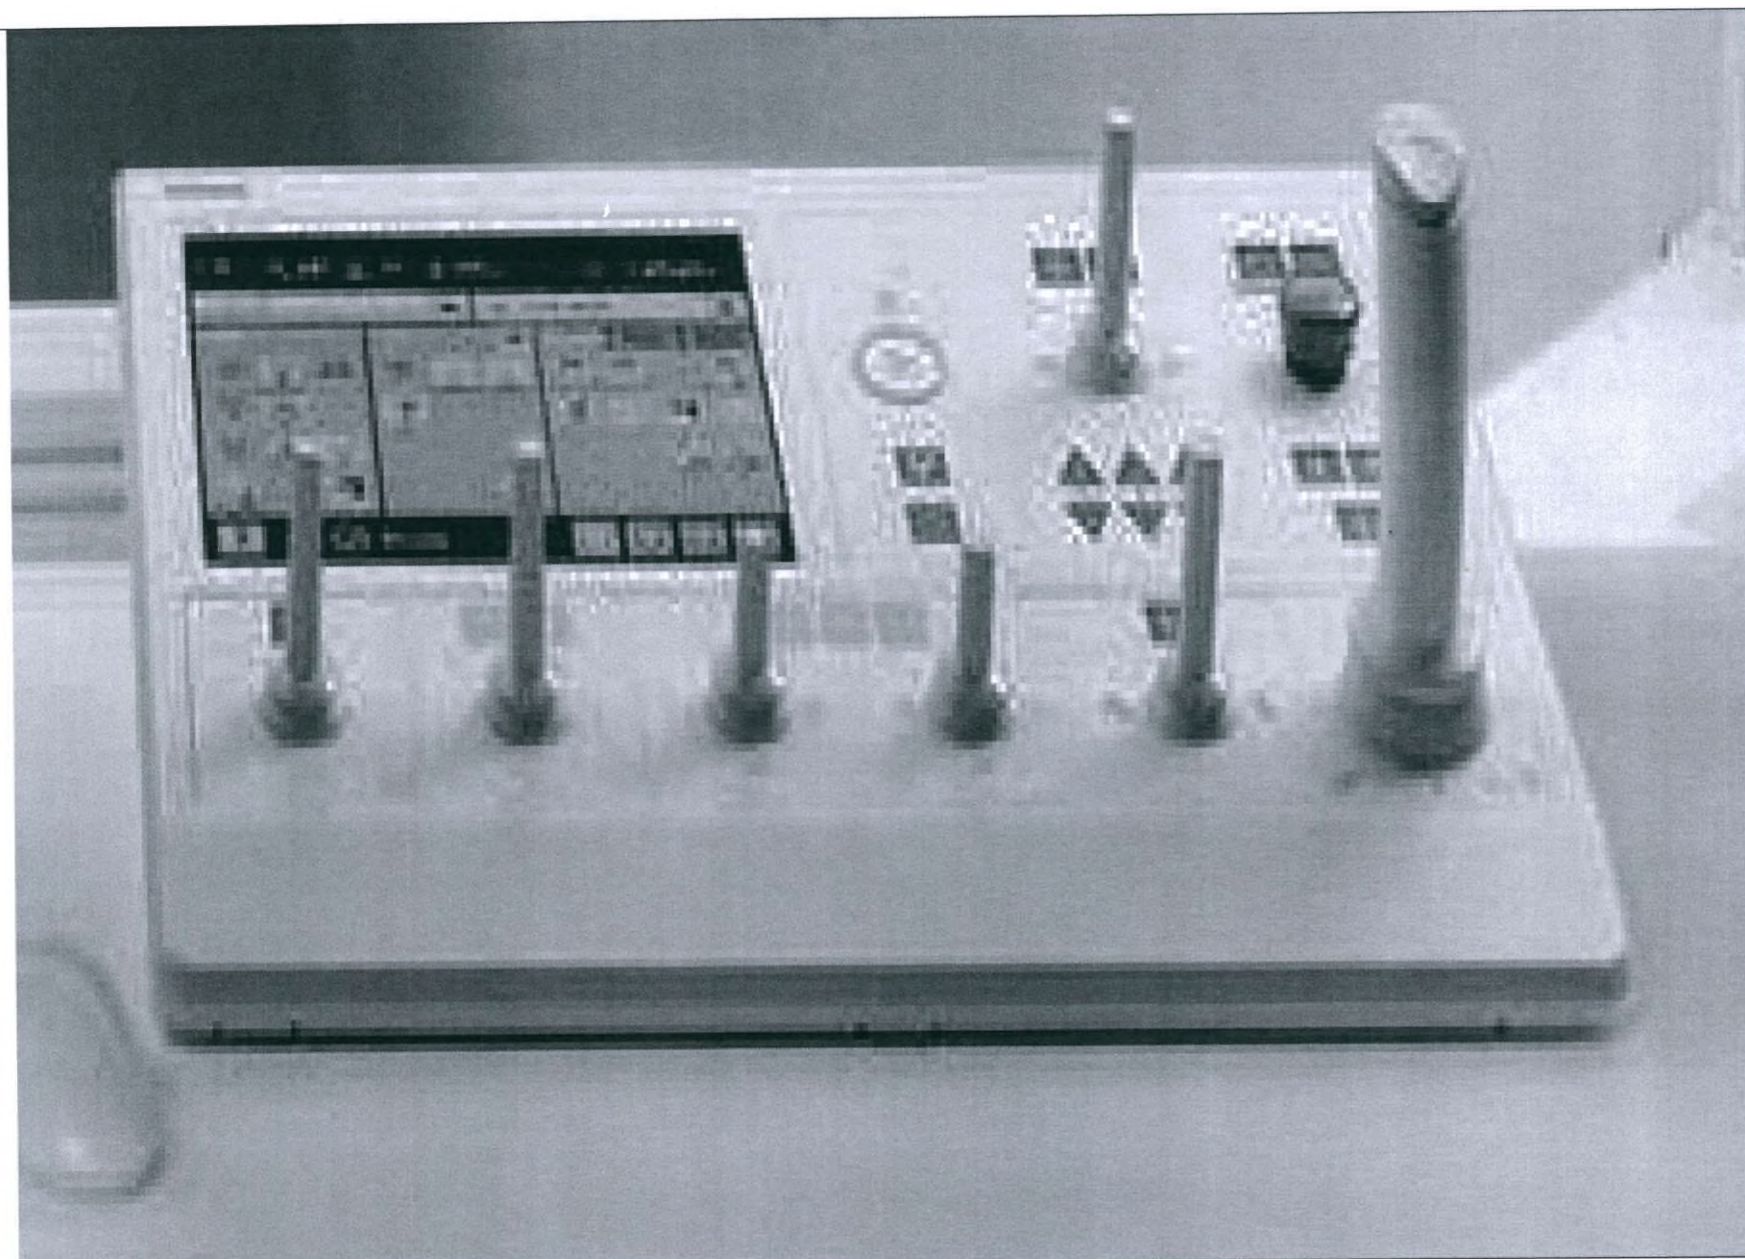


6. Дистанционный пульт управления системой

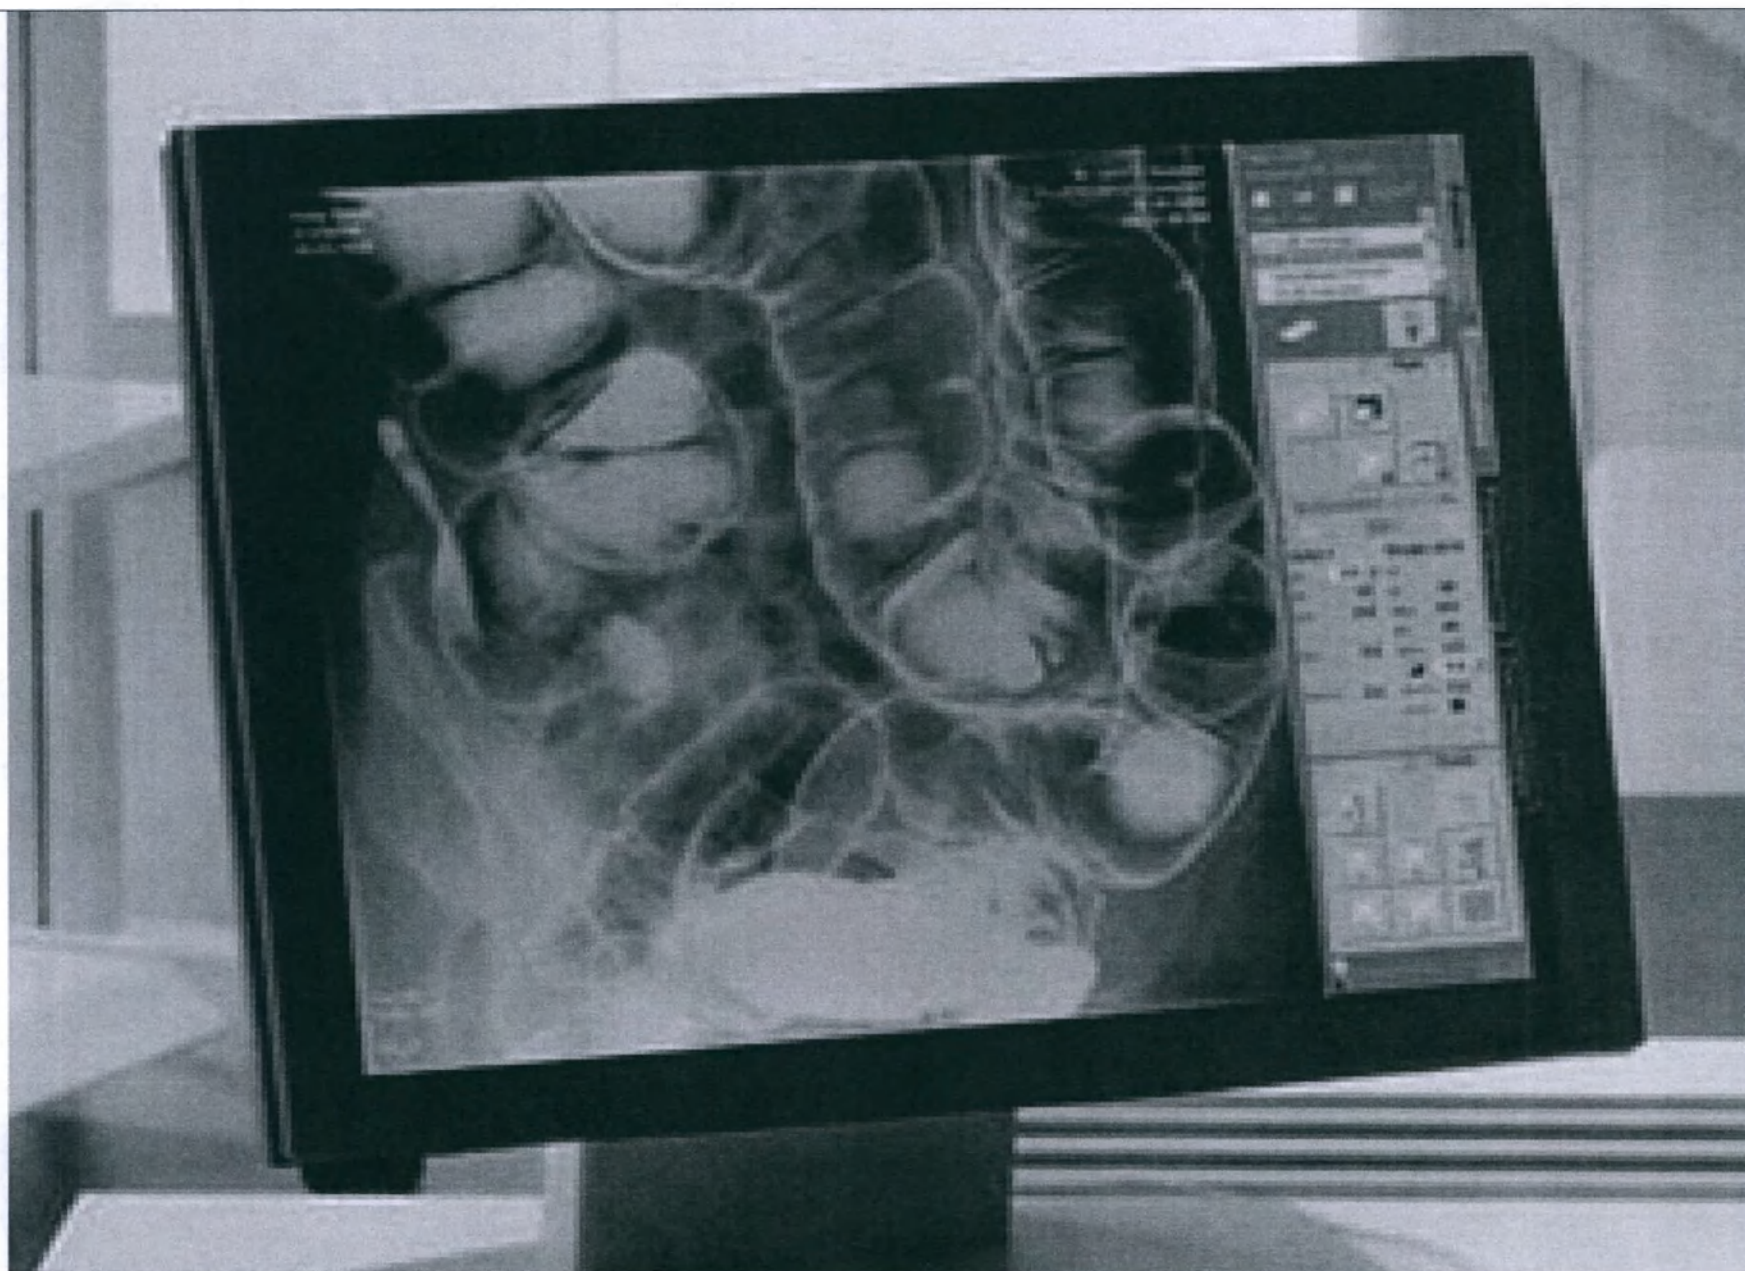

7. Дисплей для пультовой




8.1 Система формирования изображений FLUOROSPOT Compact с базовым программным обеспечением, мышью и клавиатурой

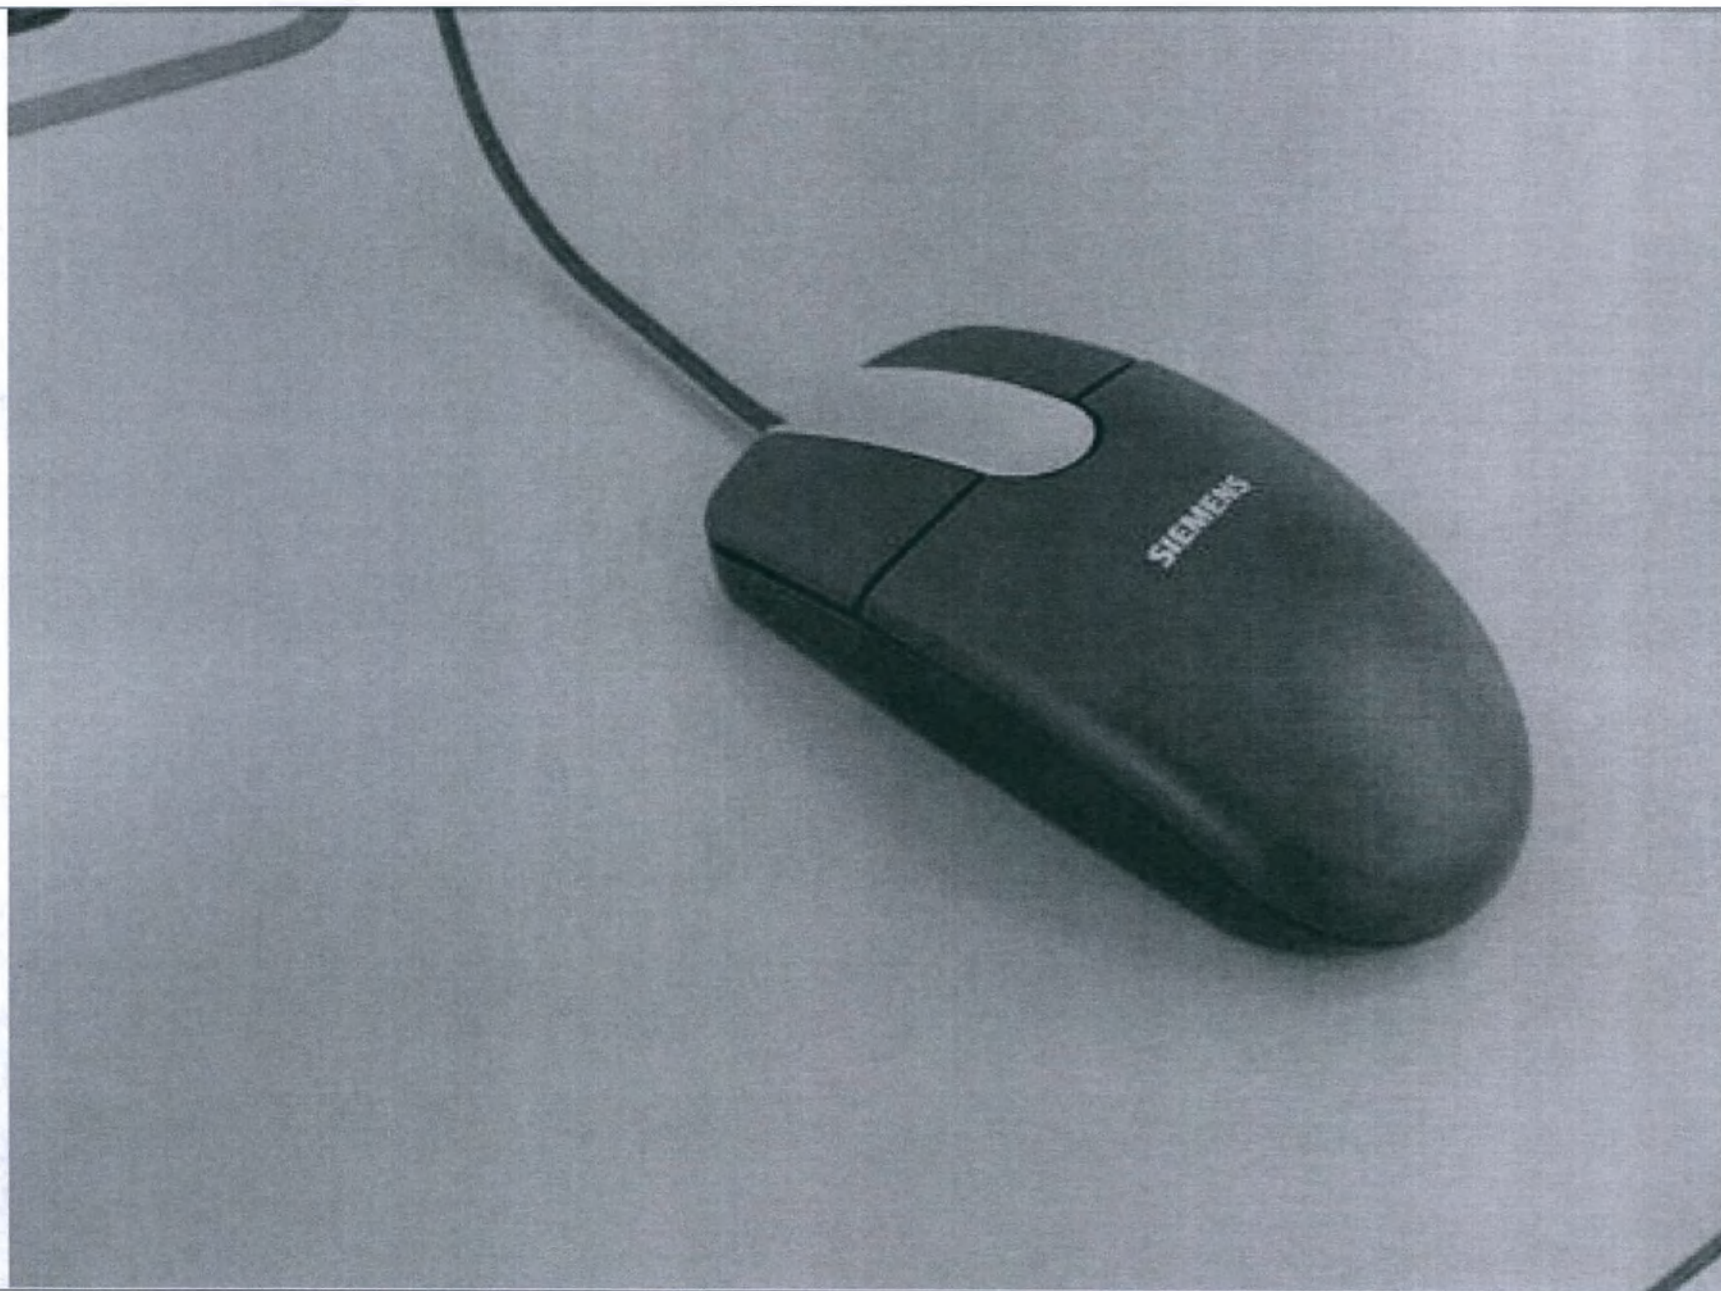


8.2 Система формирования изображений FLUOROSPOT Compact с базовым программным обеспечением, мышью и клавиатурой




8.3 Система формирования изображений FLUOROSPOT Compact с базовым программным обеспечением, мышью и клавиатурой.

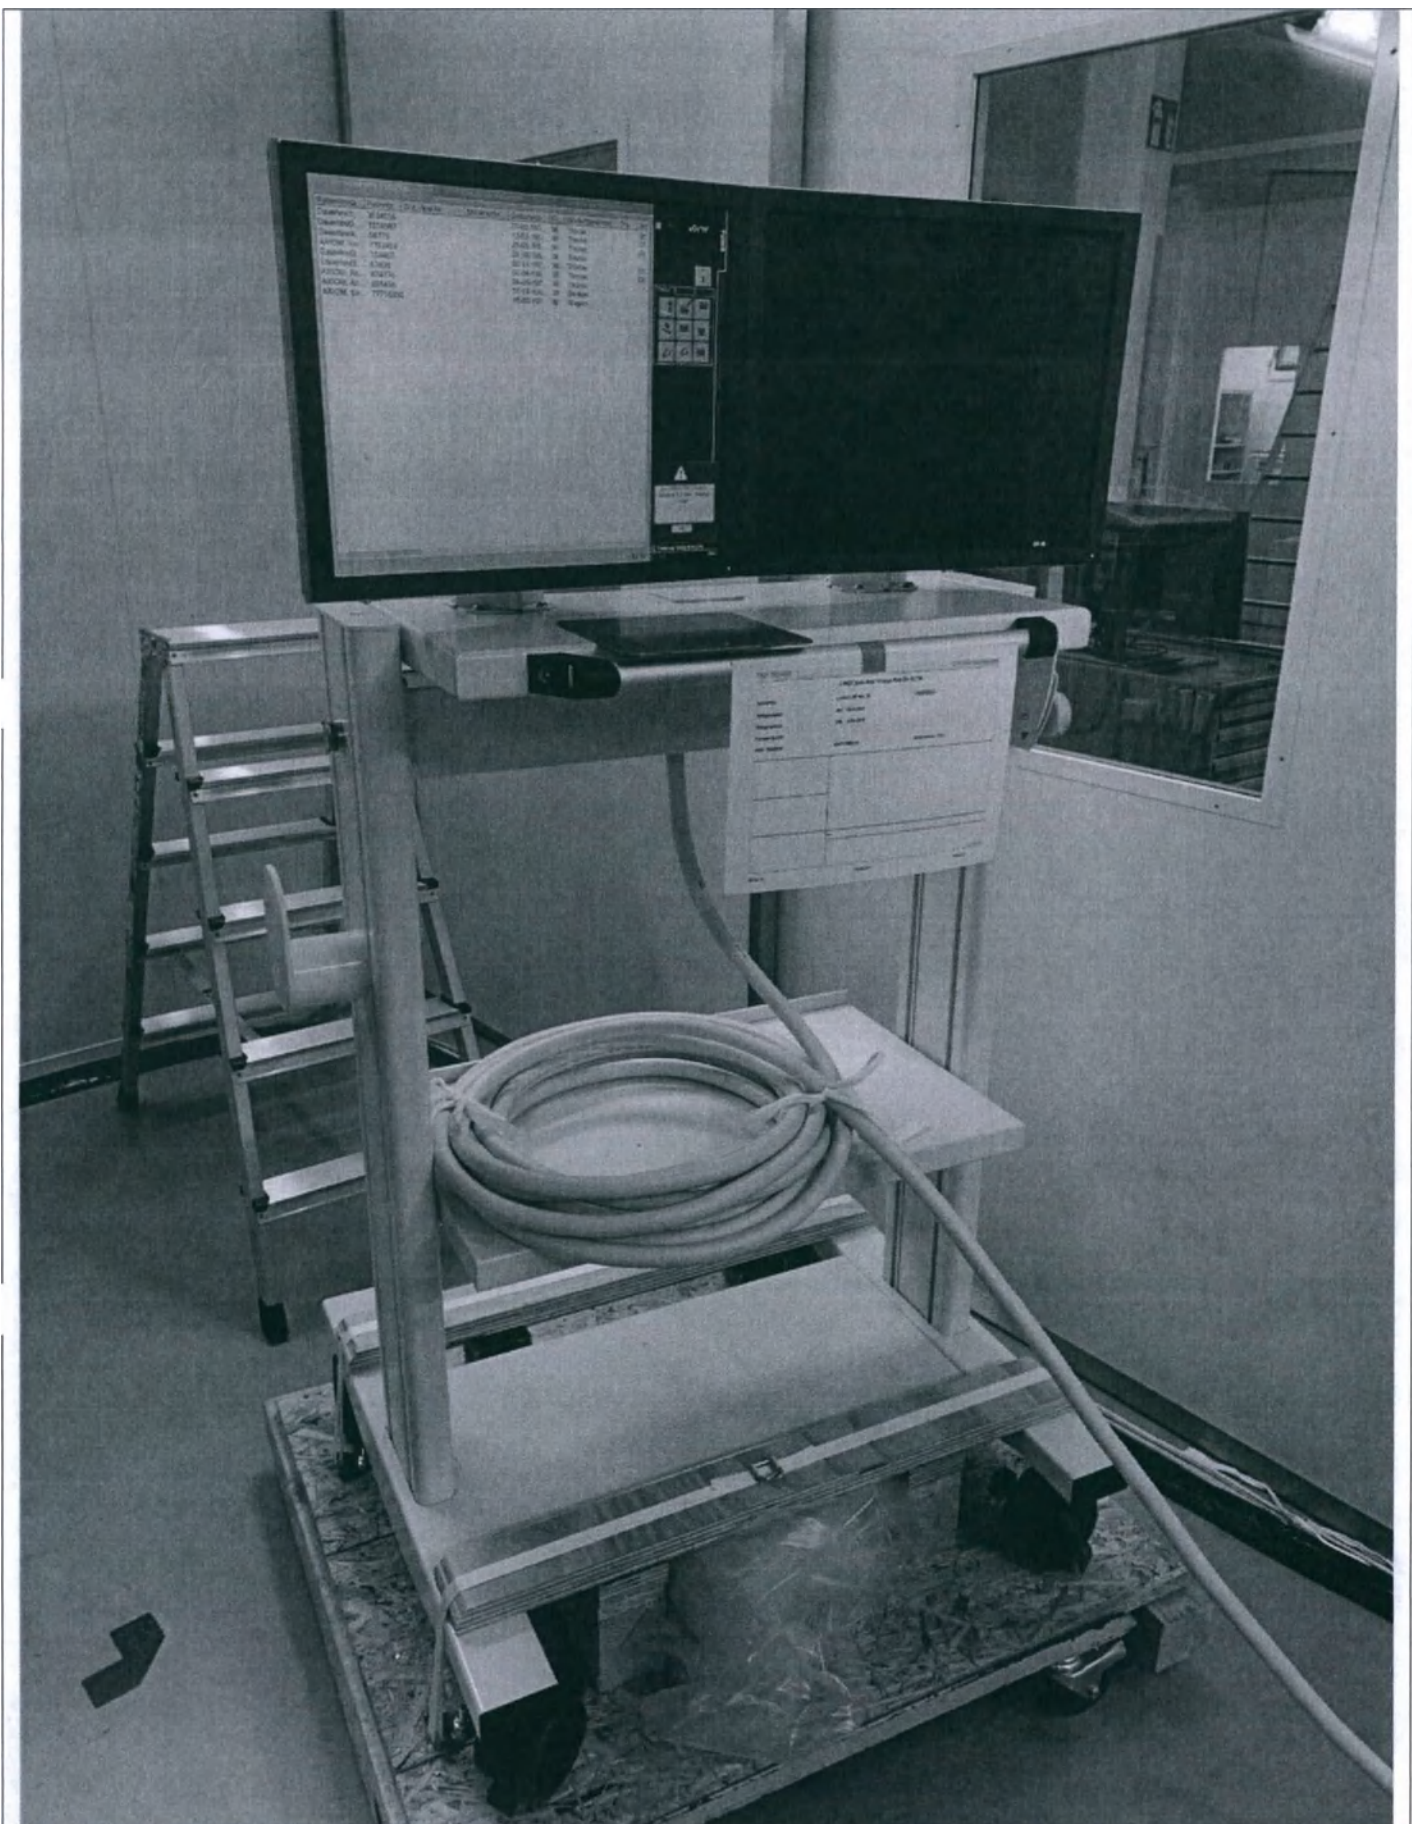

9.1 Тележка с одним или двумя дисплеями.

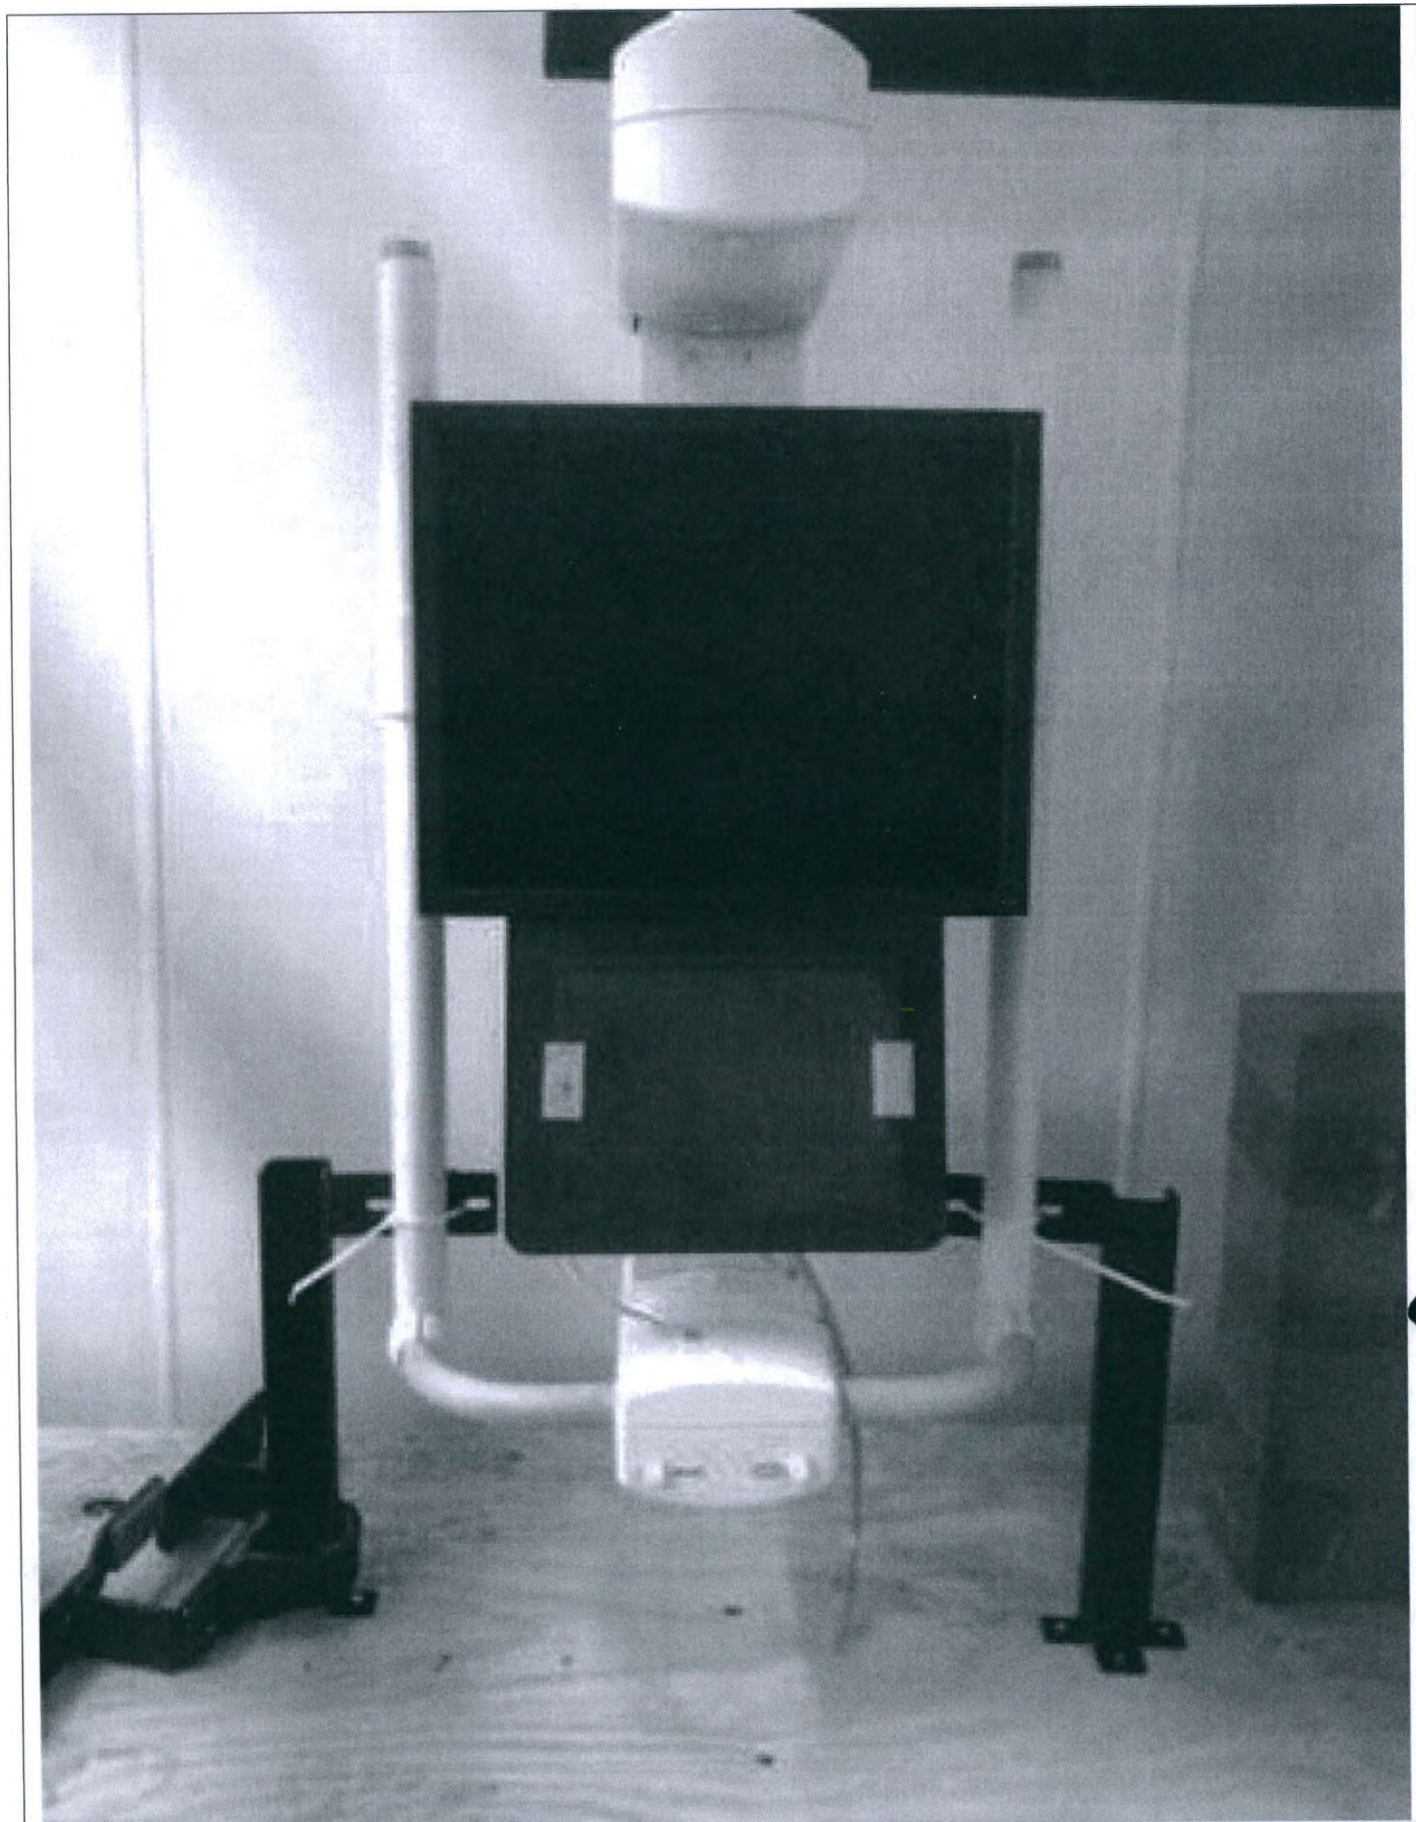


9.2 Потолочная подвеска с одним или двумя дисплеями.

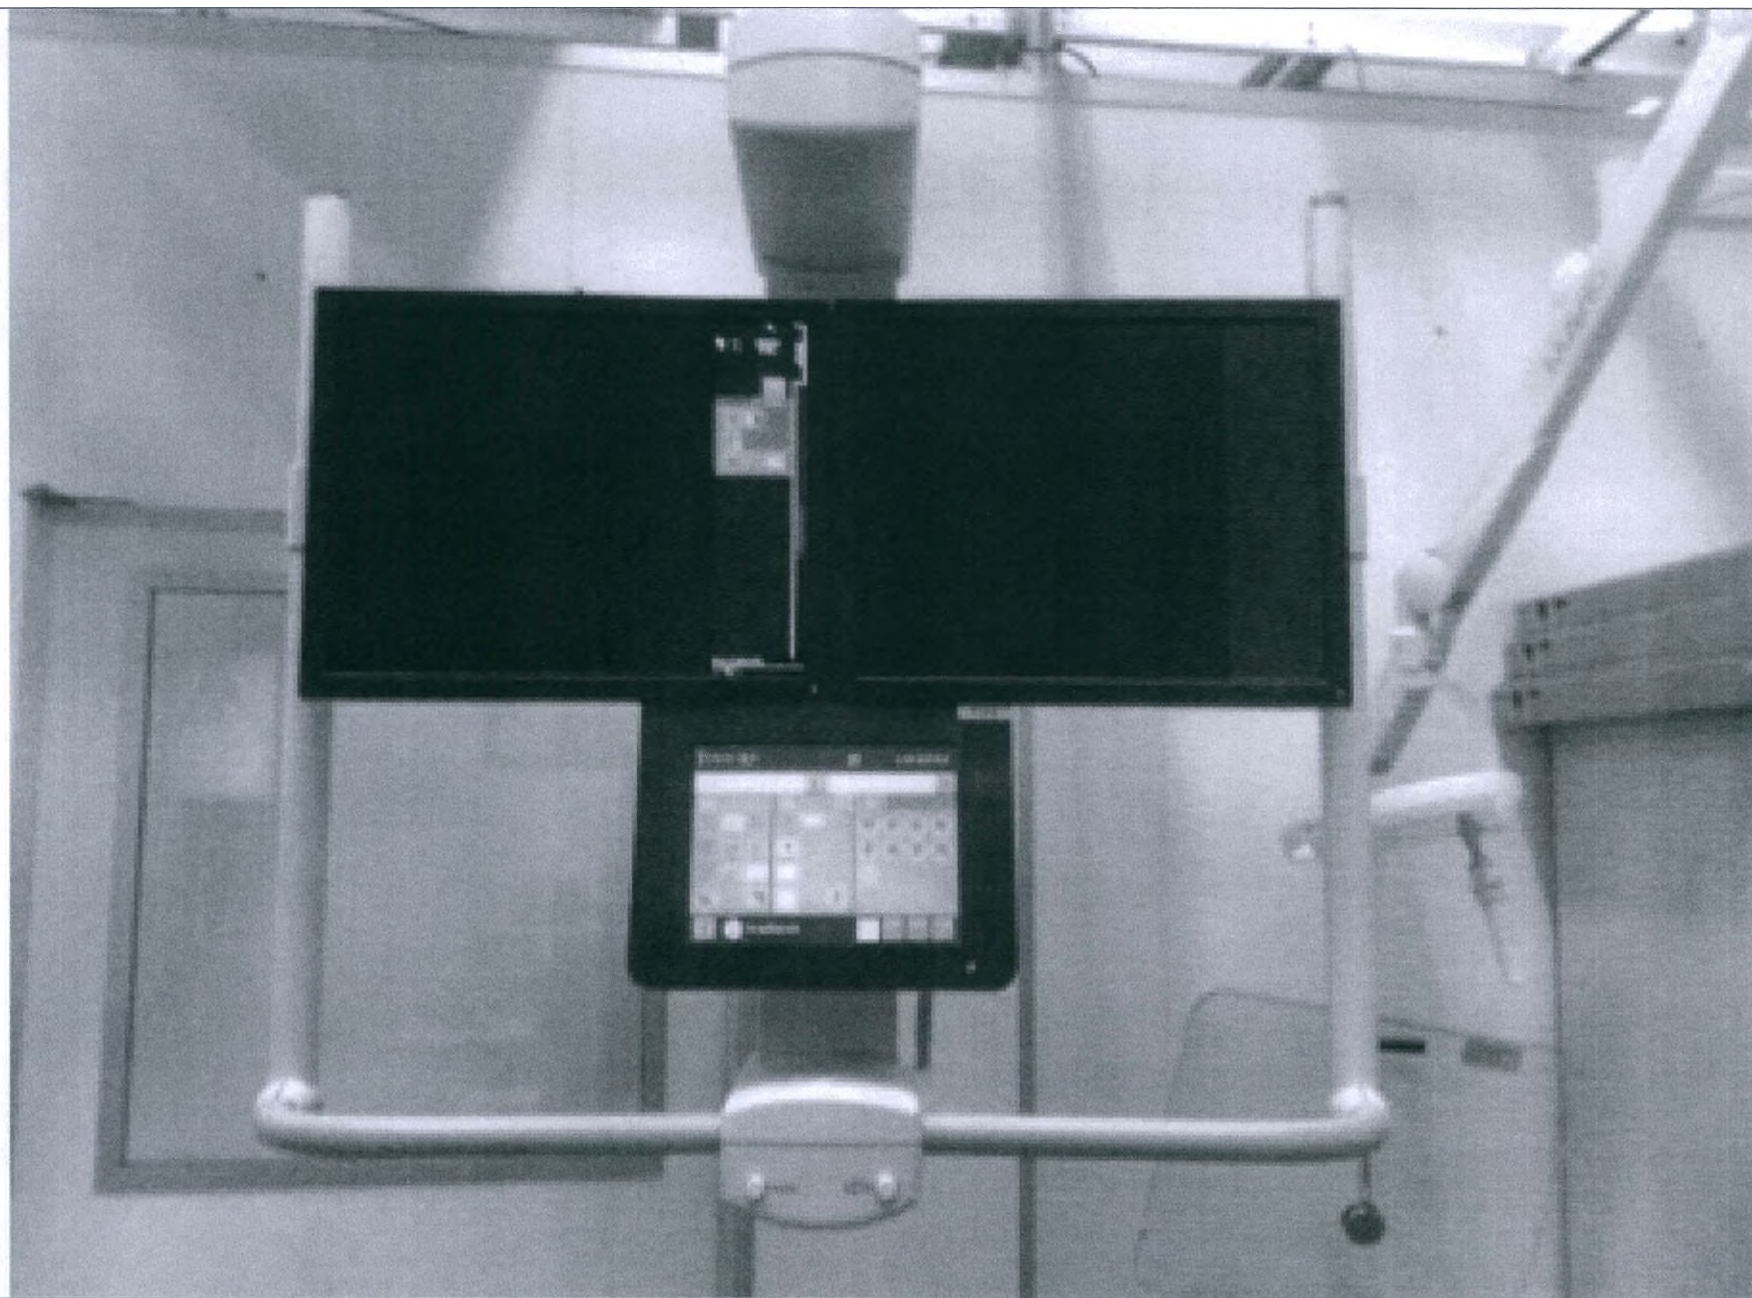


9.3 Потолочная подвеска с одним или двумя дисплеями



10. Педальный переключатель для рентгеноскопии и рентгенографии.

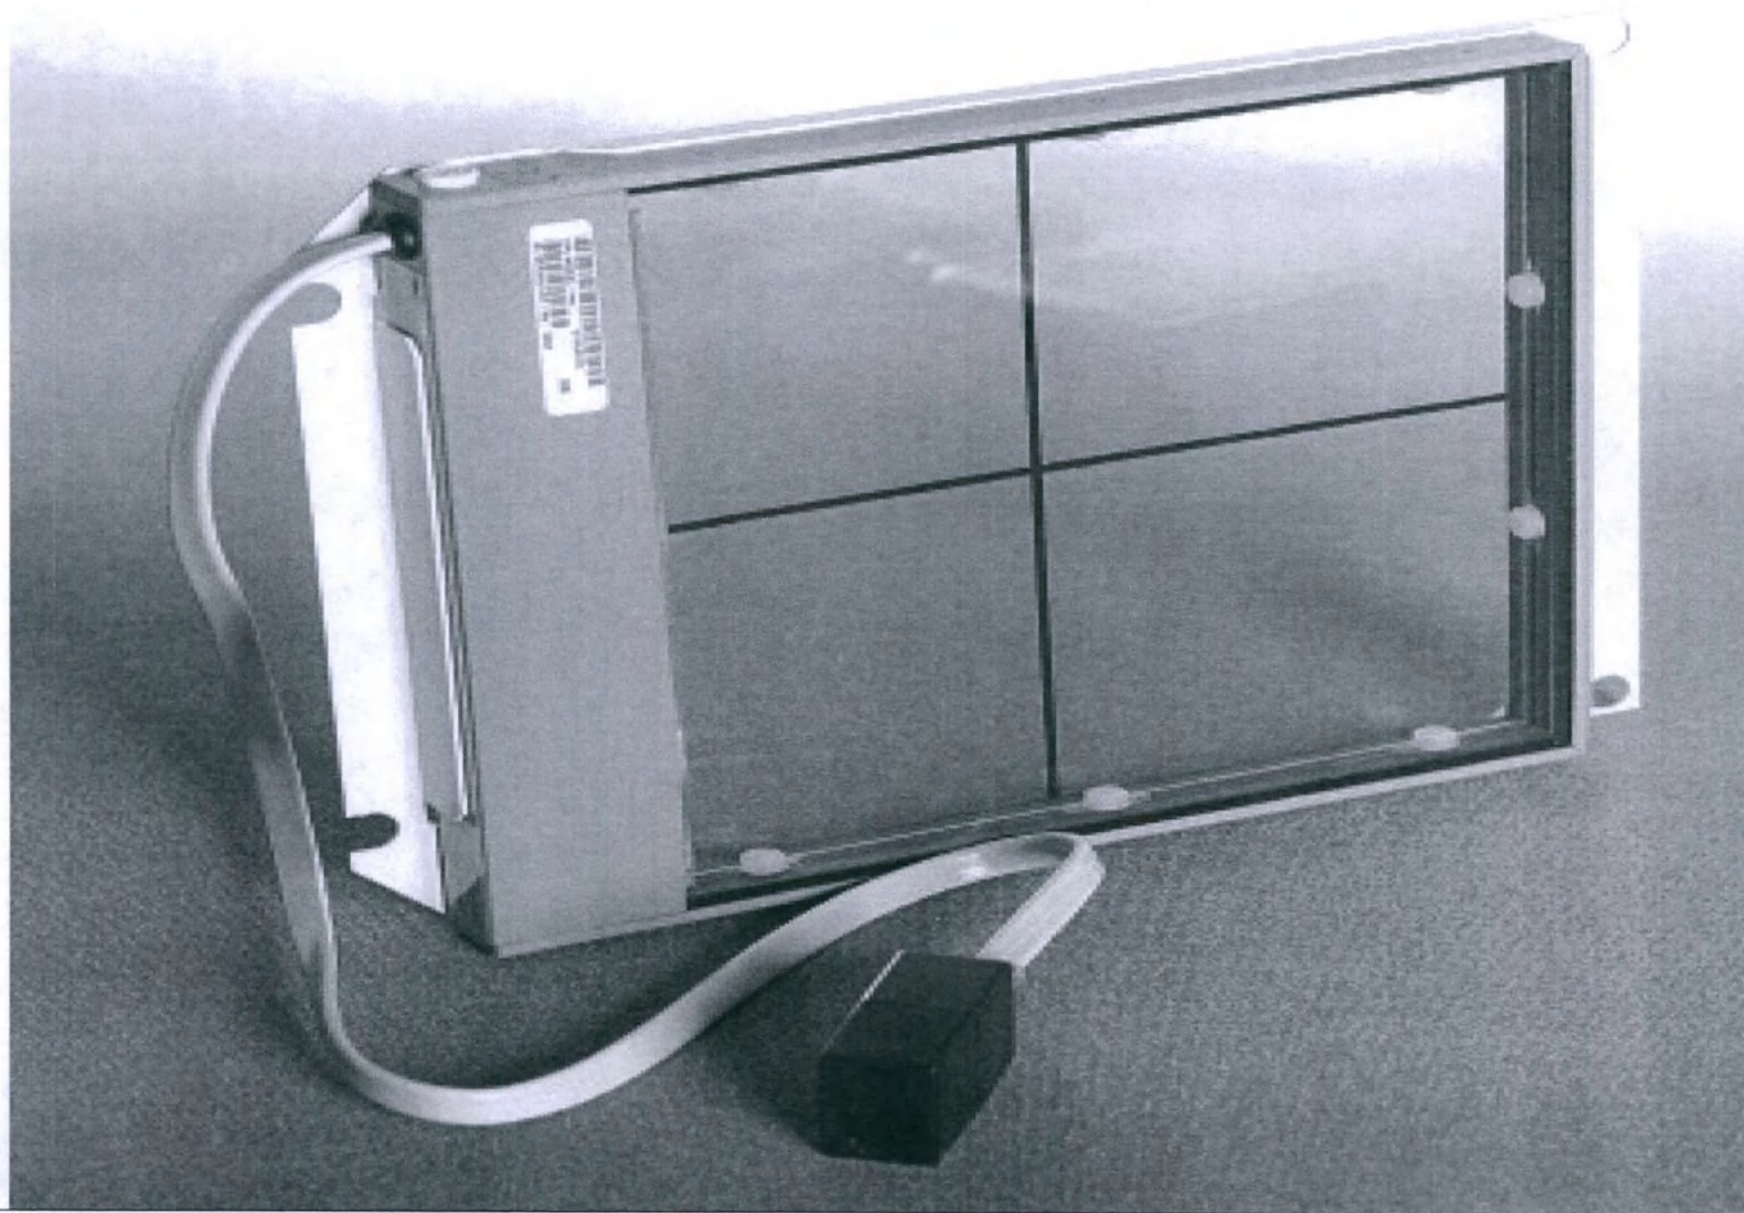

11. Устройство измерения суммарной поверхностной дозы.

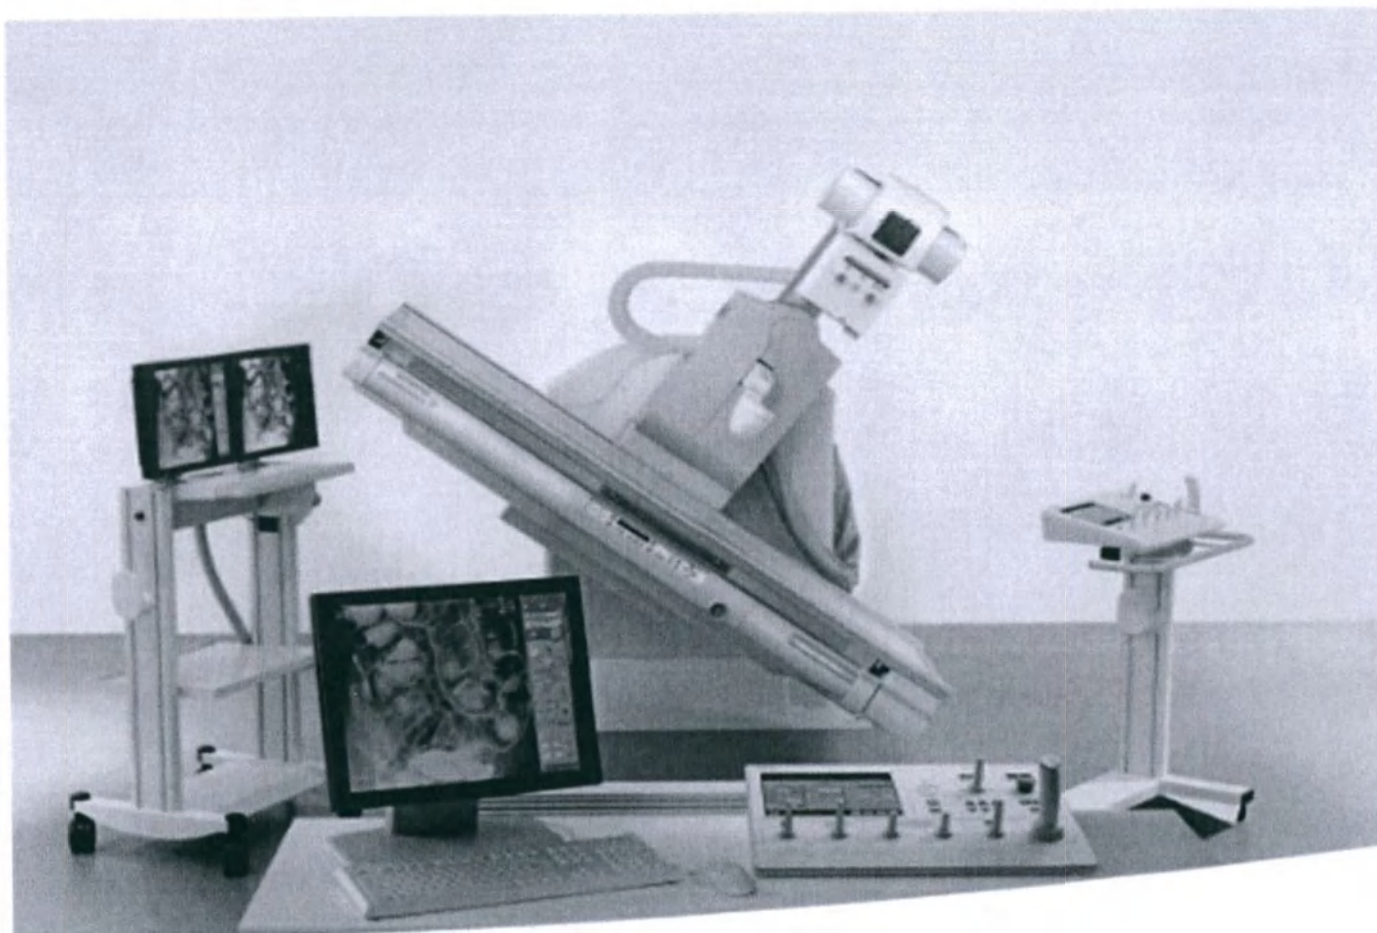


Luminos dRF Max

Руководство пользователя – VF11 и более поздние версии

siemens-healthineers.com


SIEMENS
Healthineers

12. Документация пользователя на русском языке.

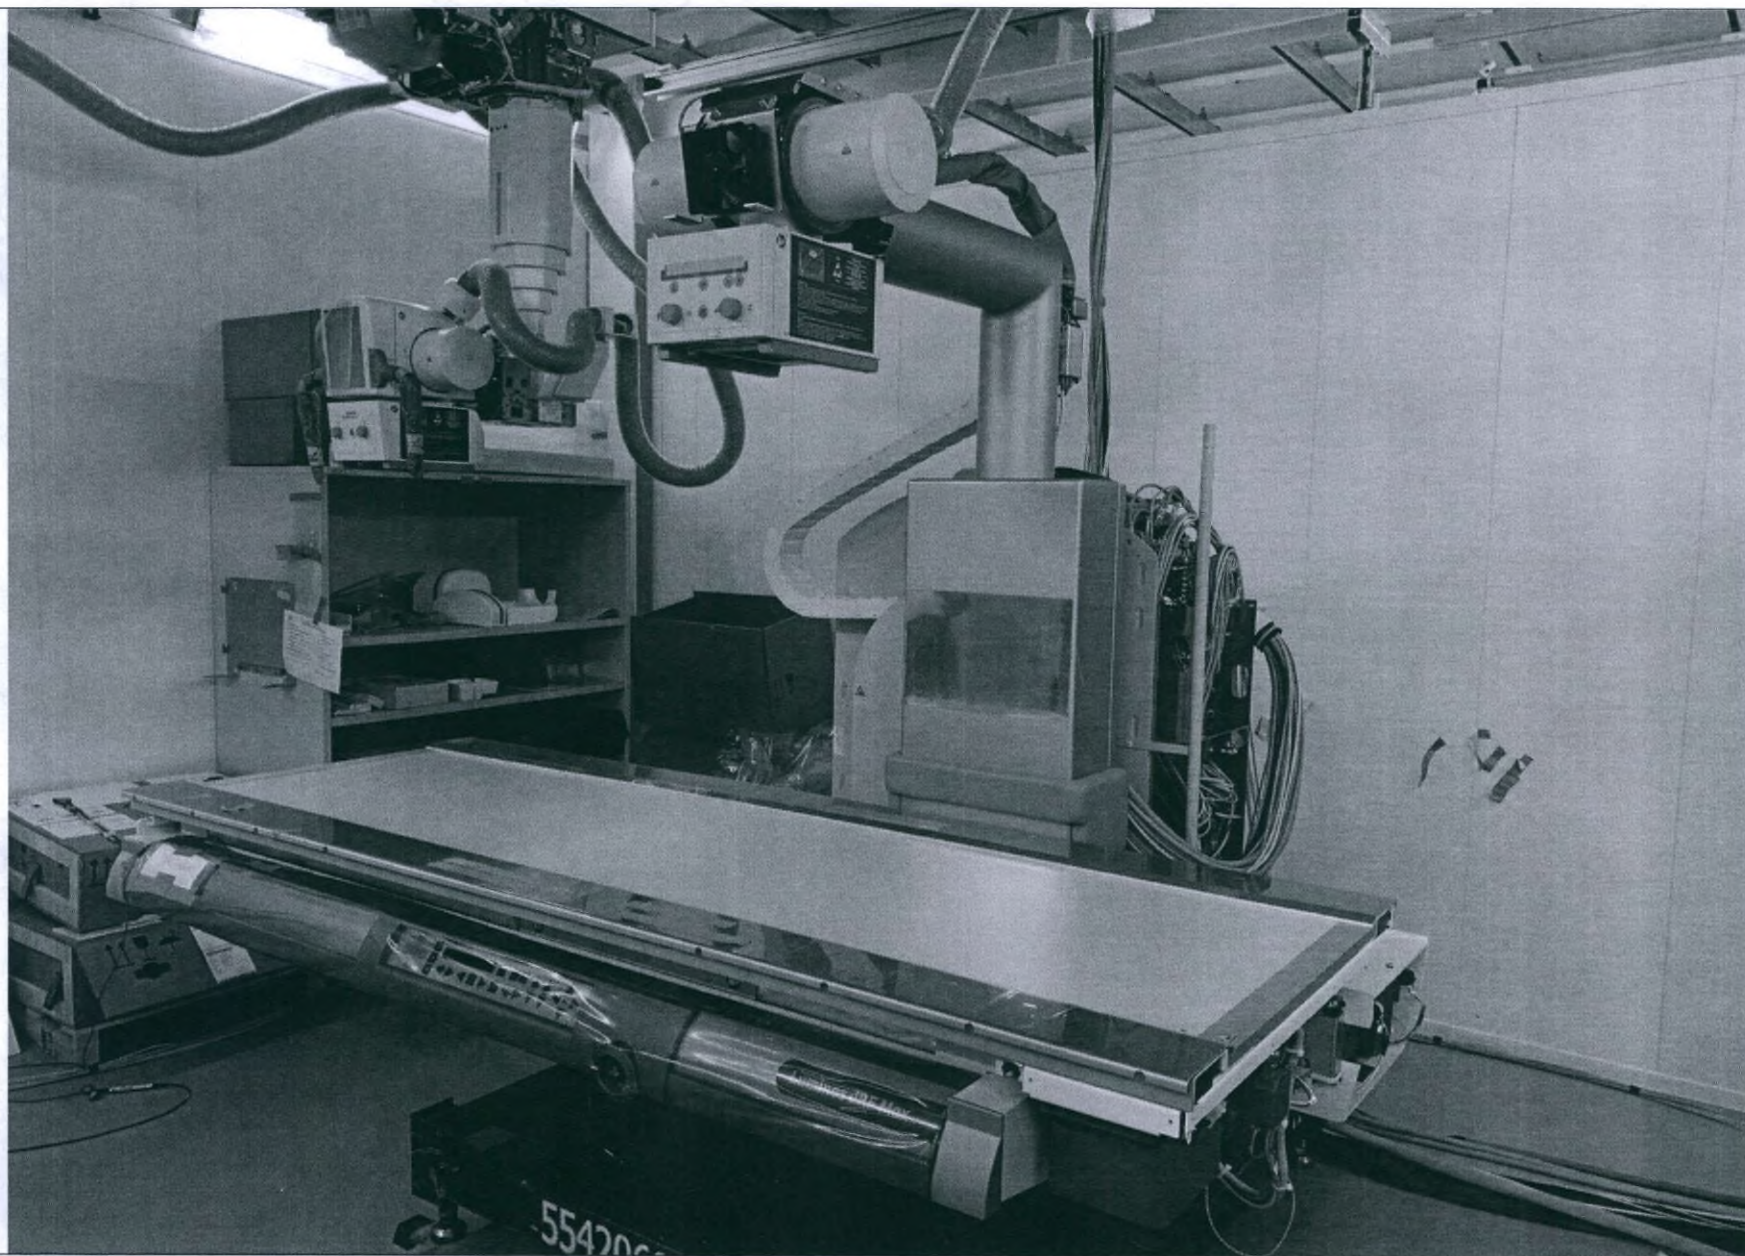


1. Телеуправляемый стол-штатив Luminos dRF Max


2. Базовый блок, вариант 2.

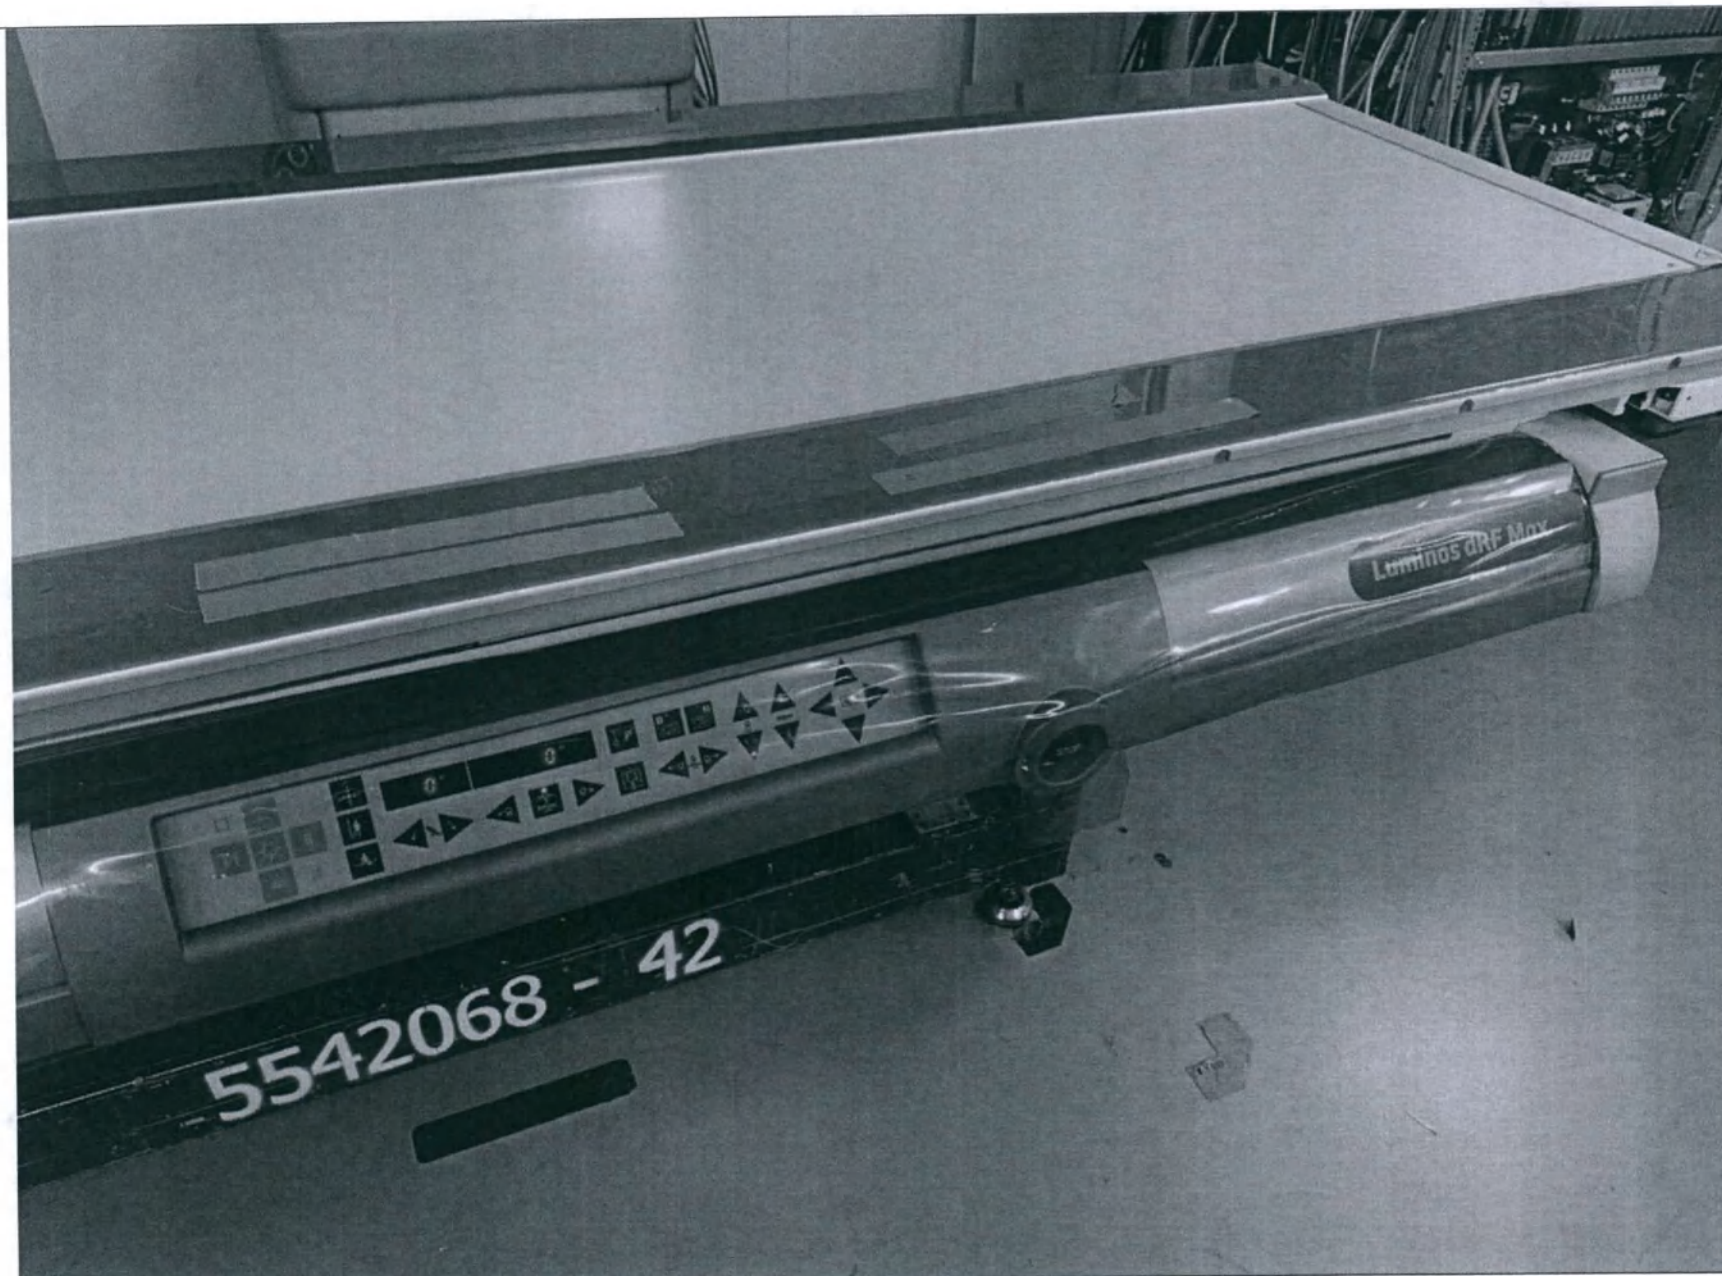


2.1 Плоский детектор.

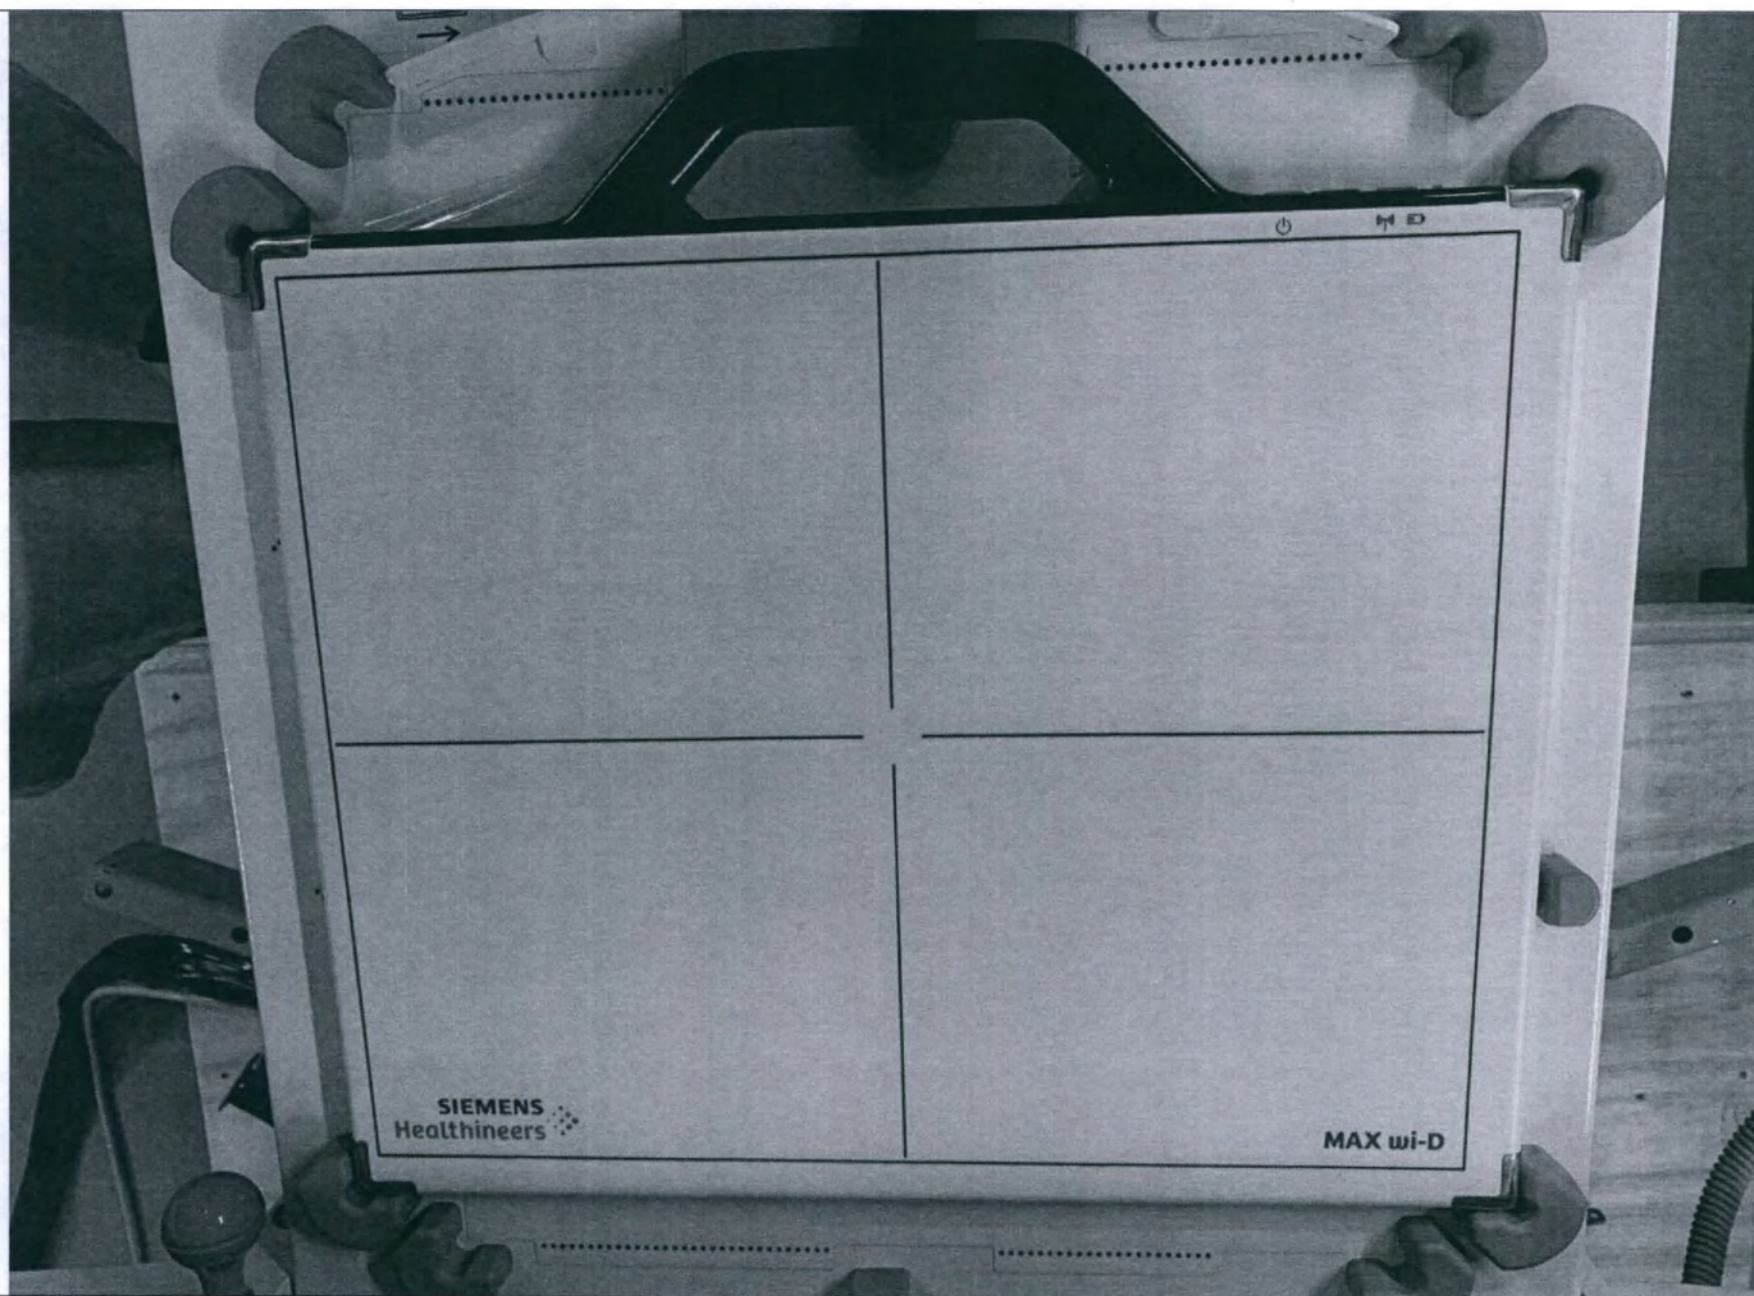


2.2 Беспроводной детектор MAX wi-D.

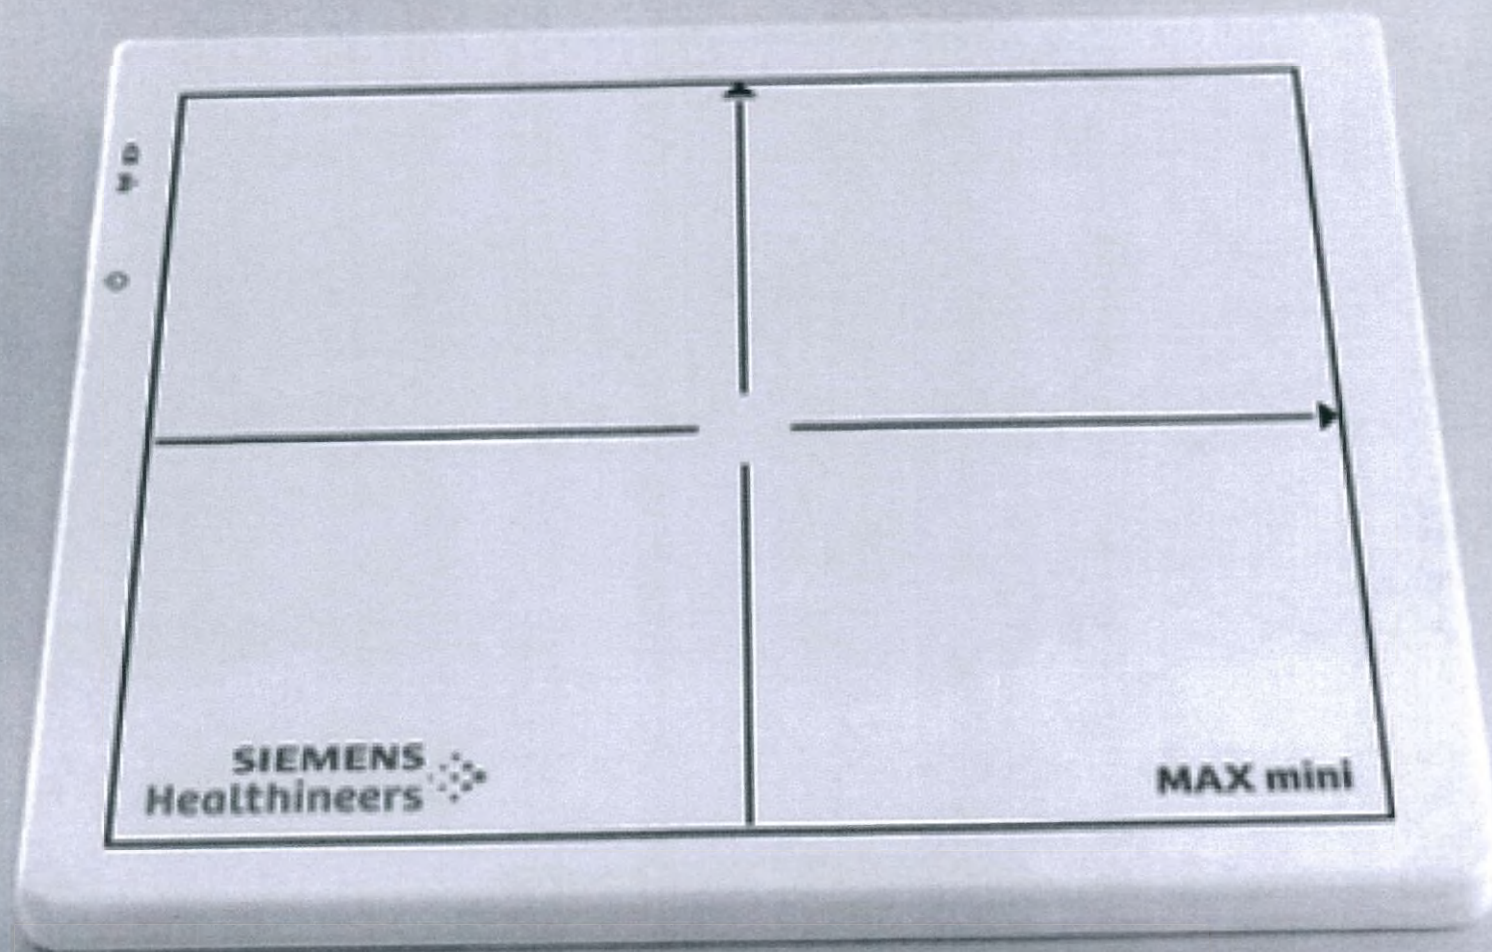


2.3 Беспроводной детектор MAX mini.

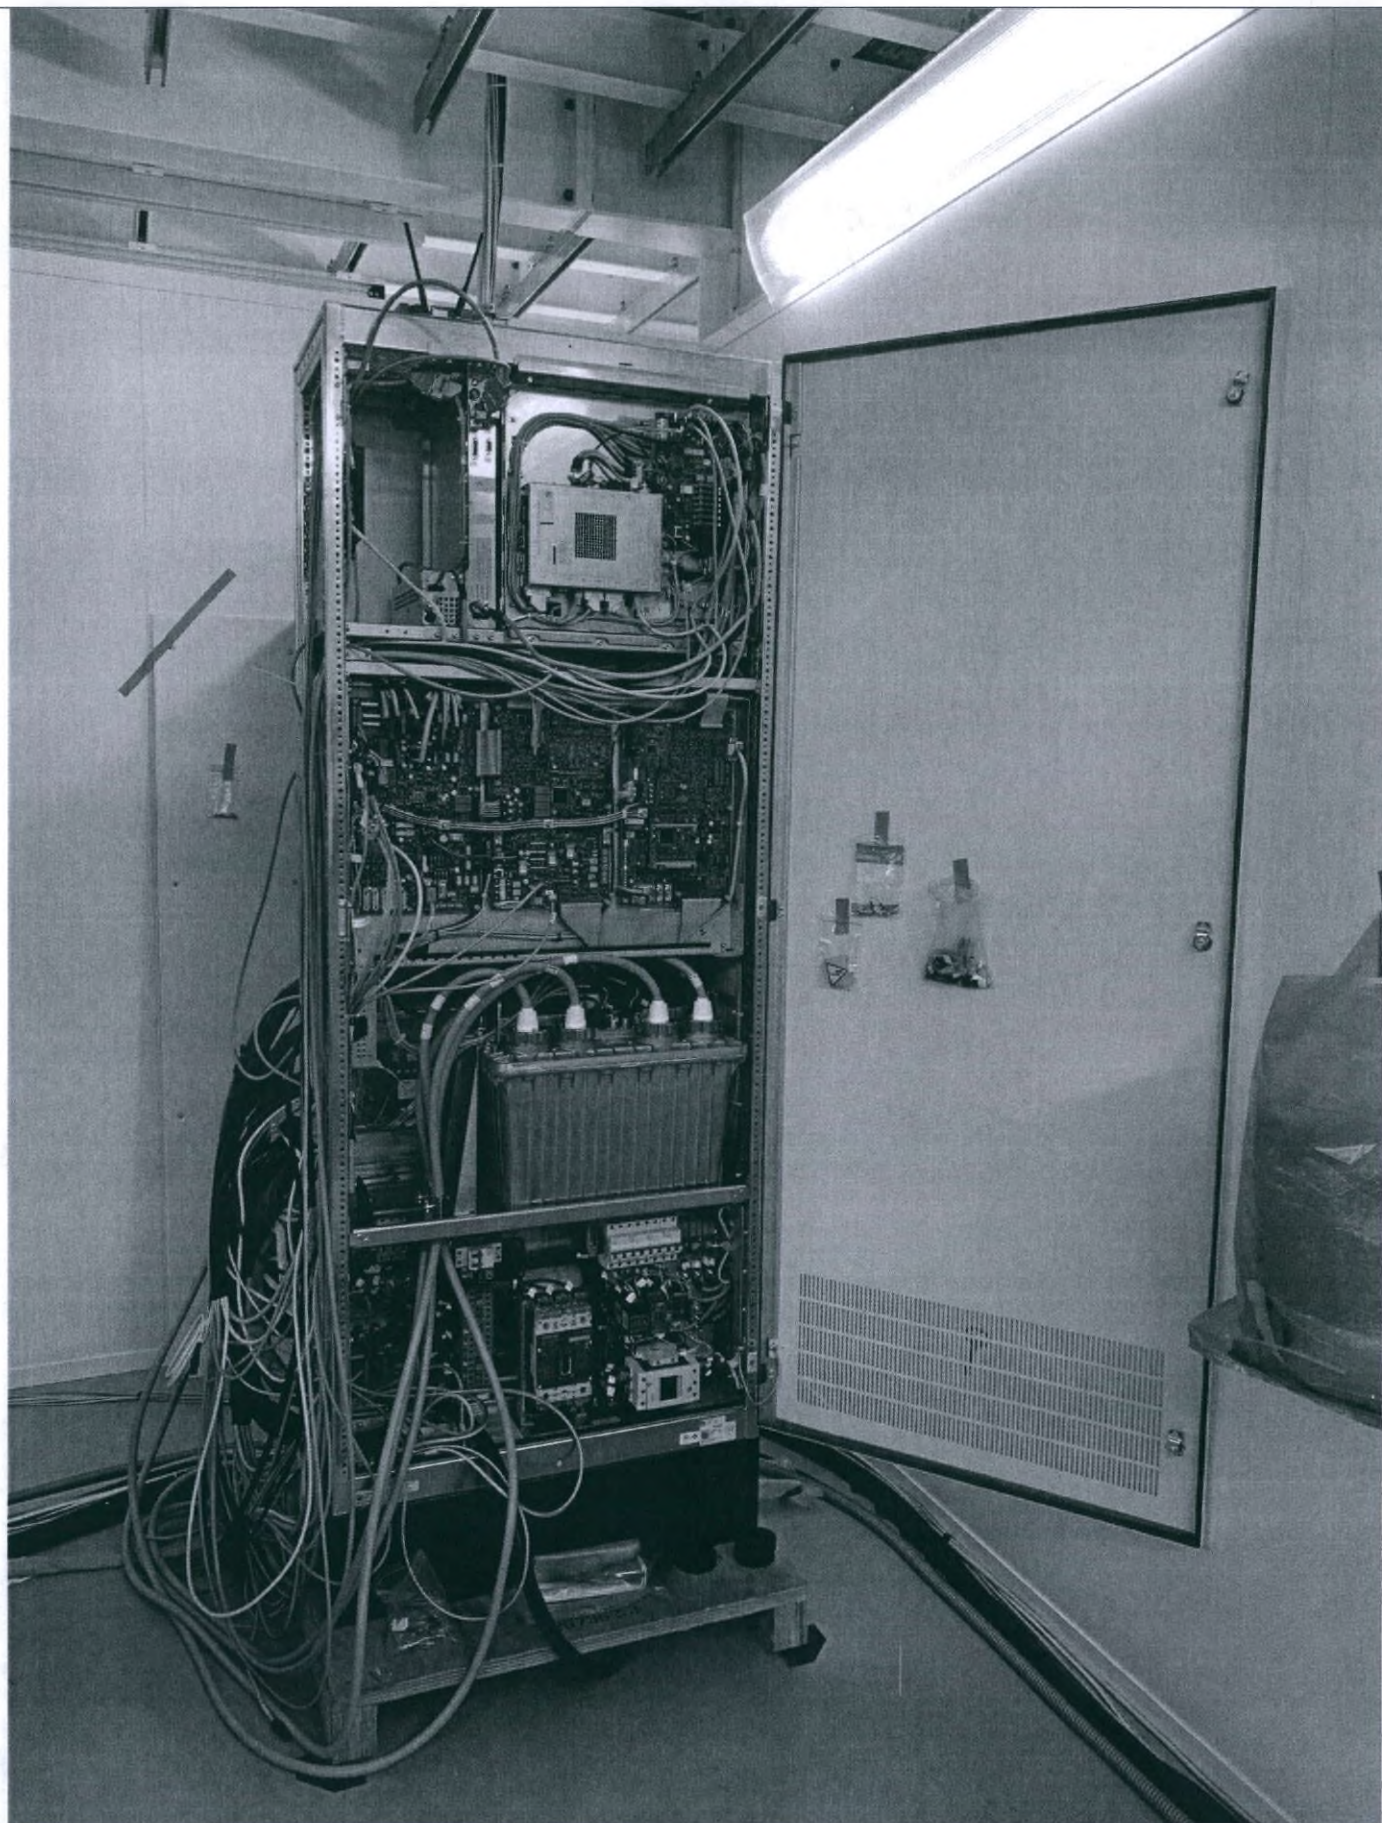


3. Генератор рентгеновский POLYDOROS F (варианты исполнения 65 кВт, 80 кВт).

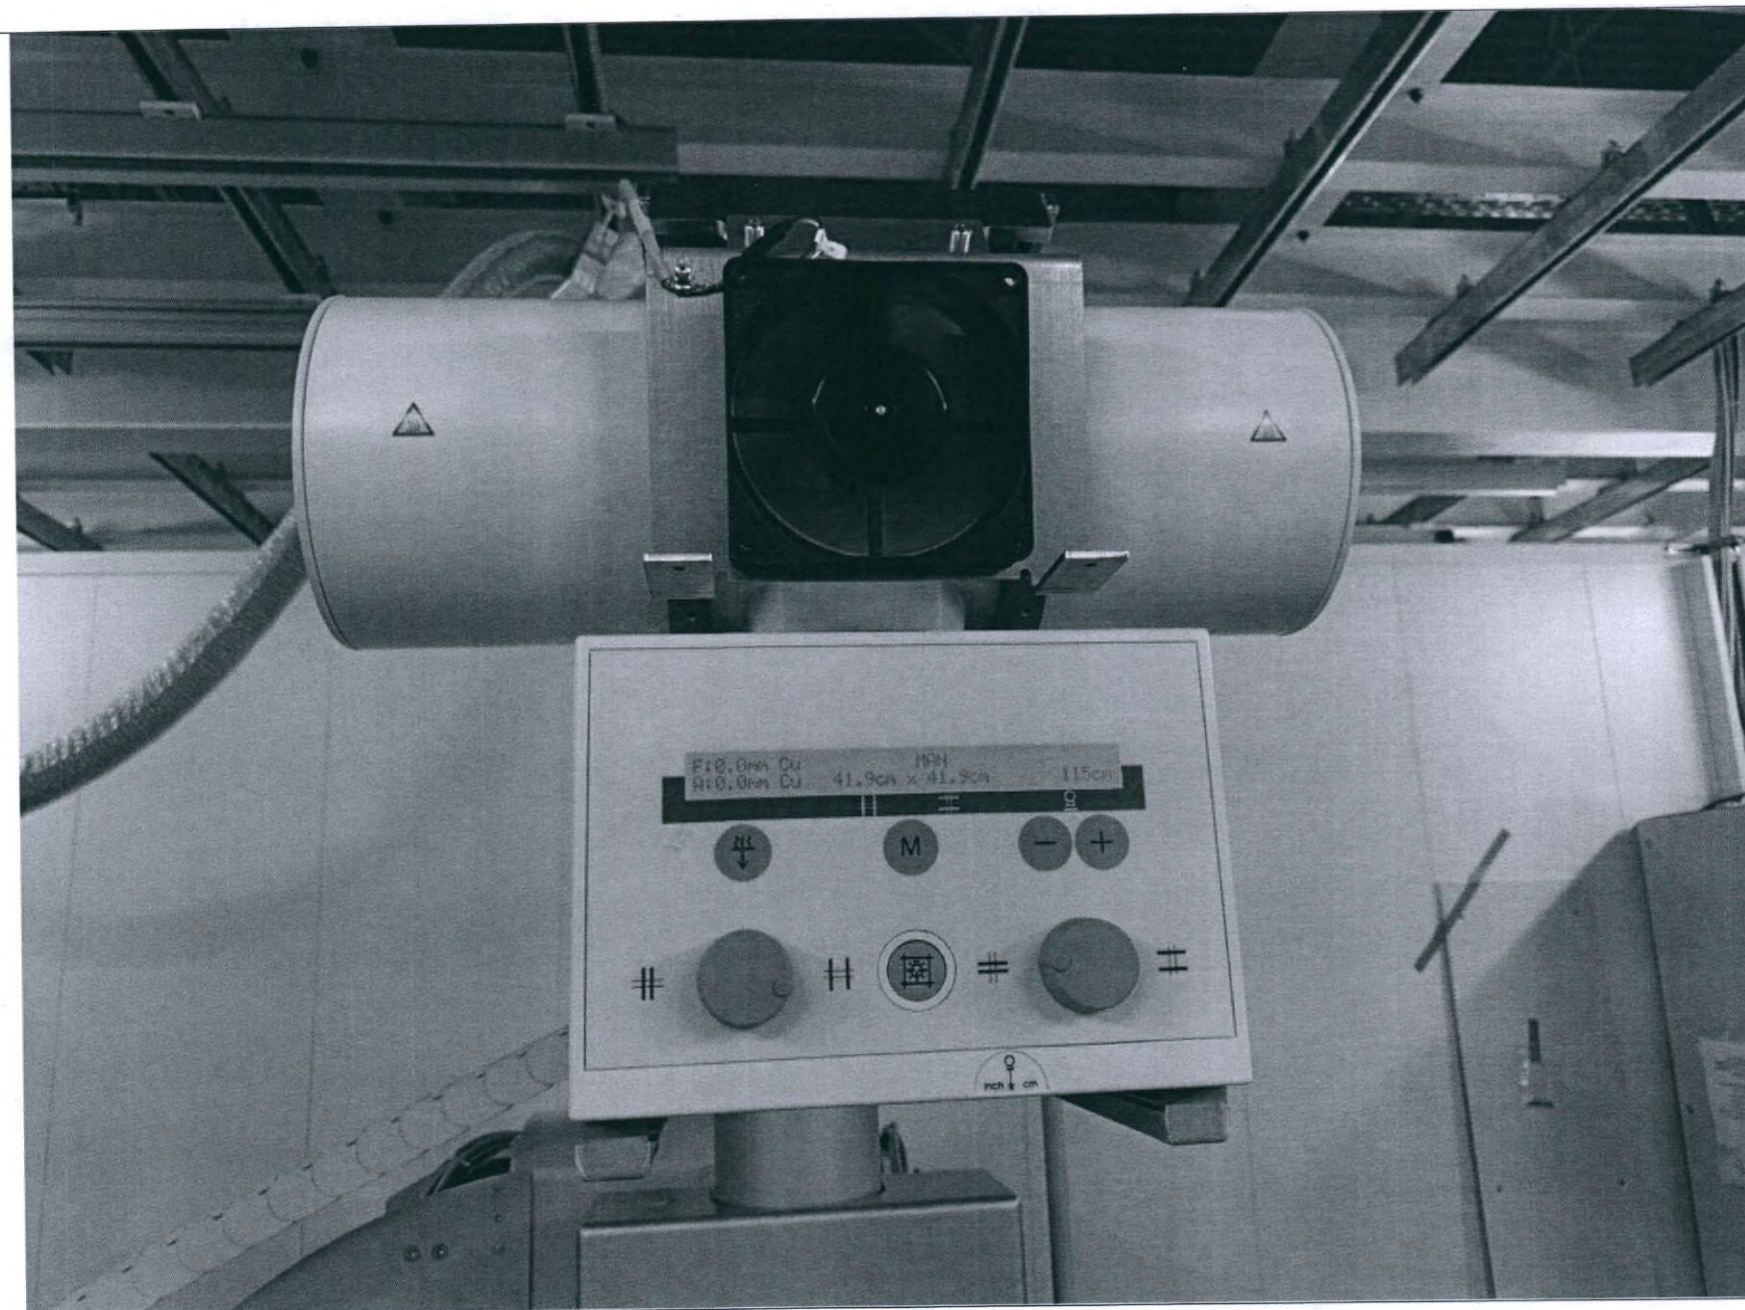


4. Рентгеновская трубка ОПТИТОР.

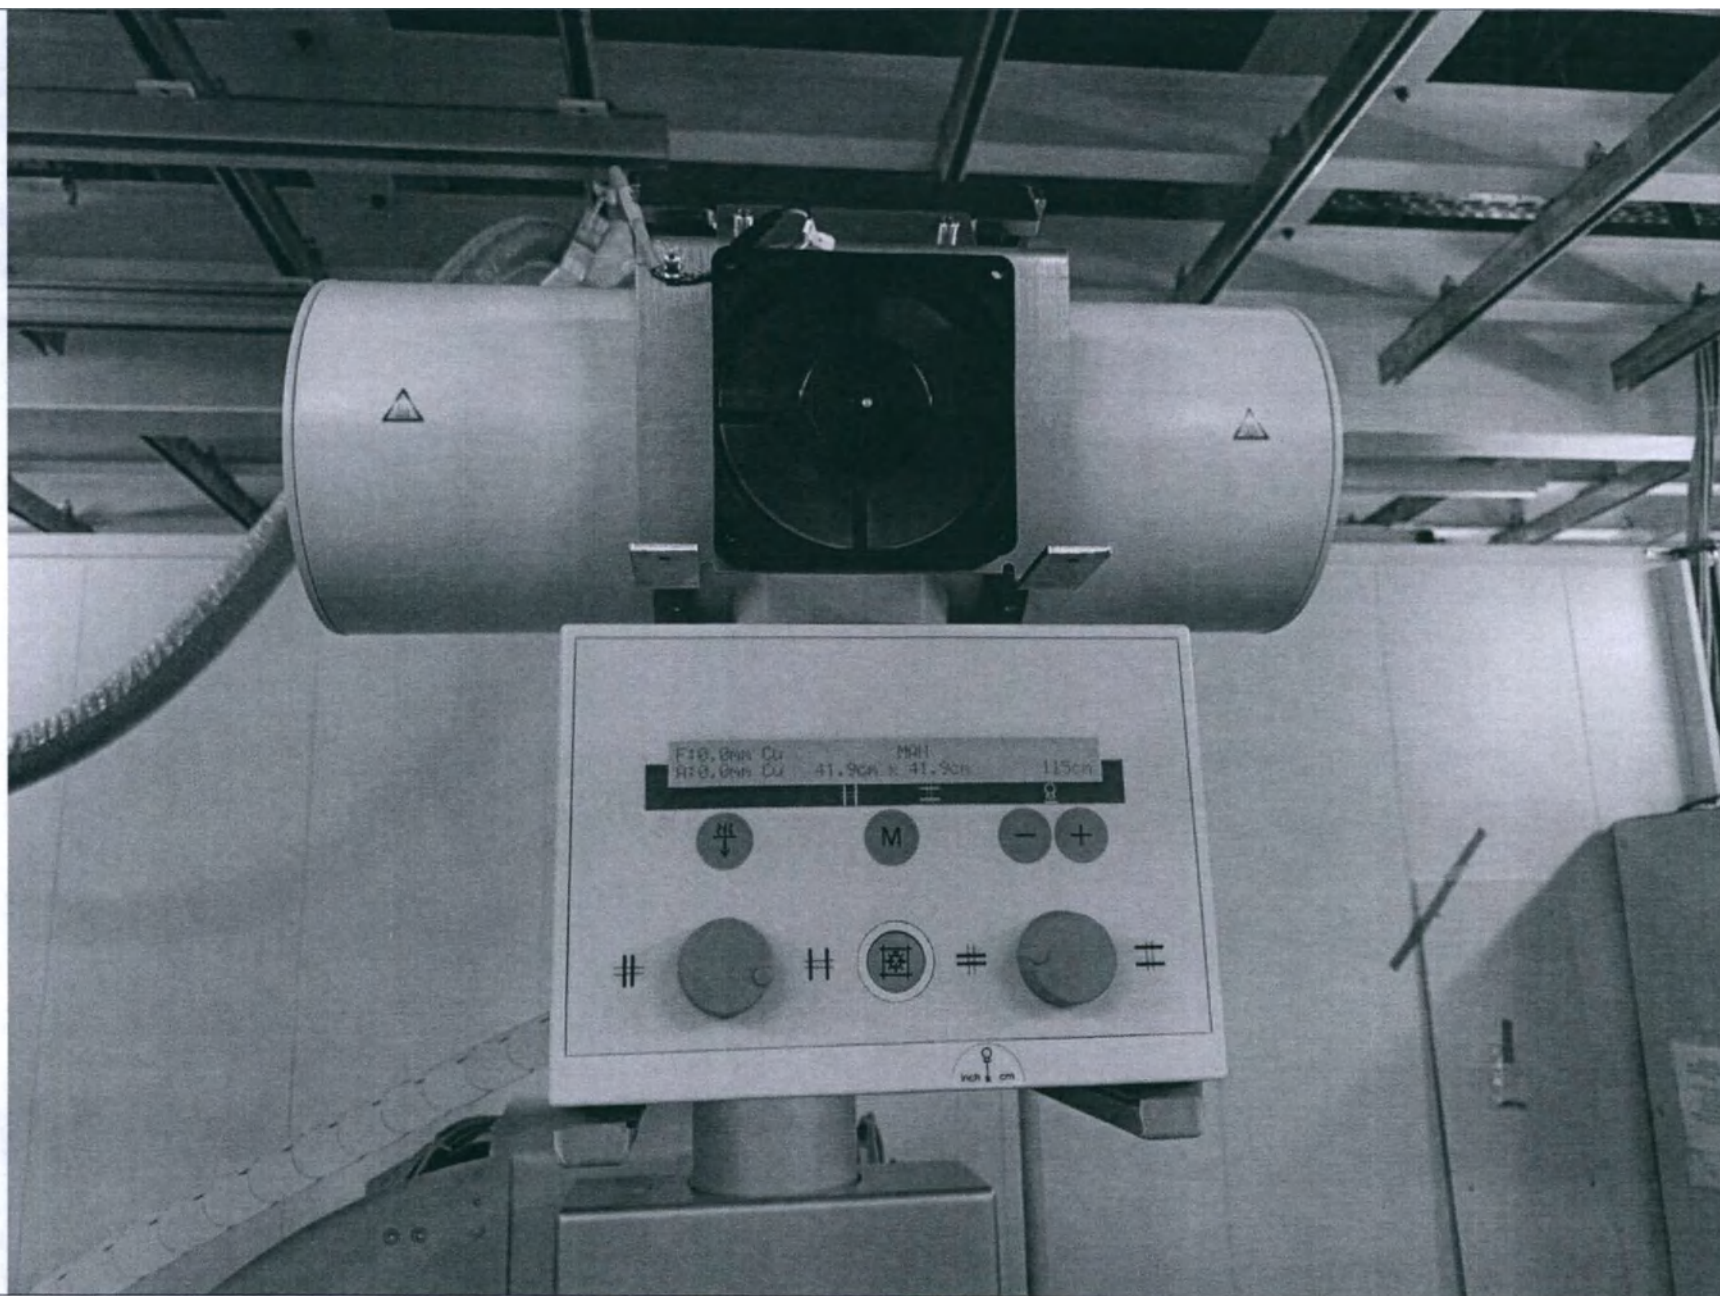

5. Многолепестковый коллиматор, варианты исполнения: стандартный; с полупрозрачными фильтрами.

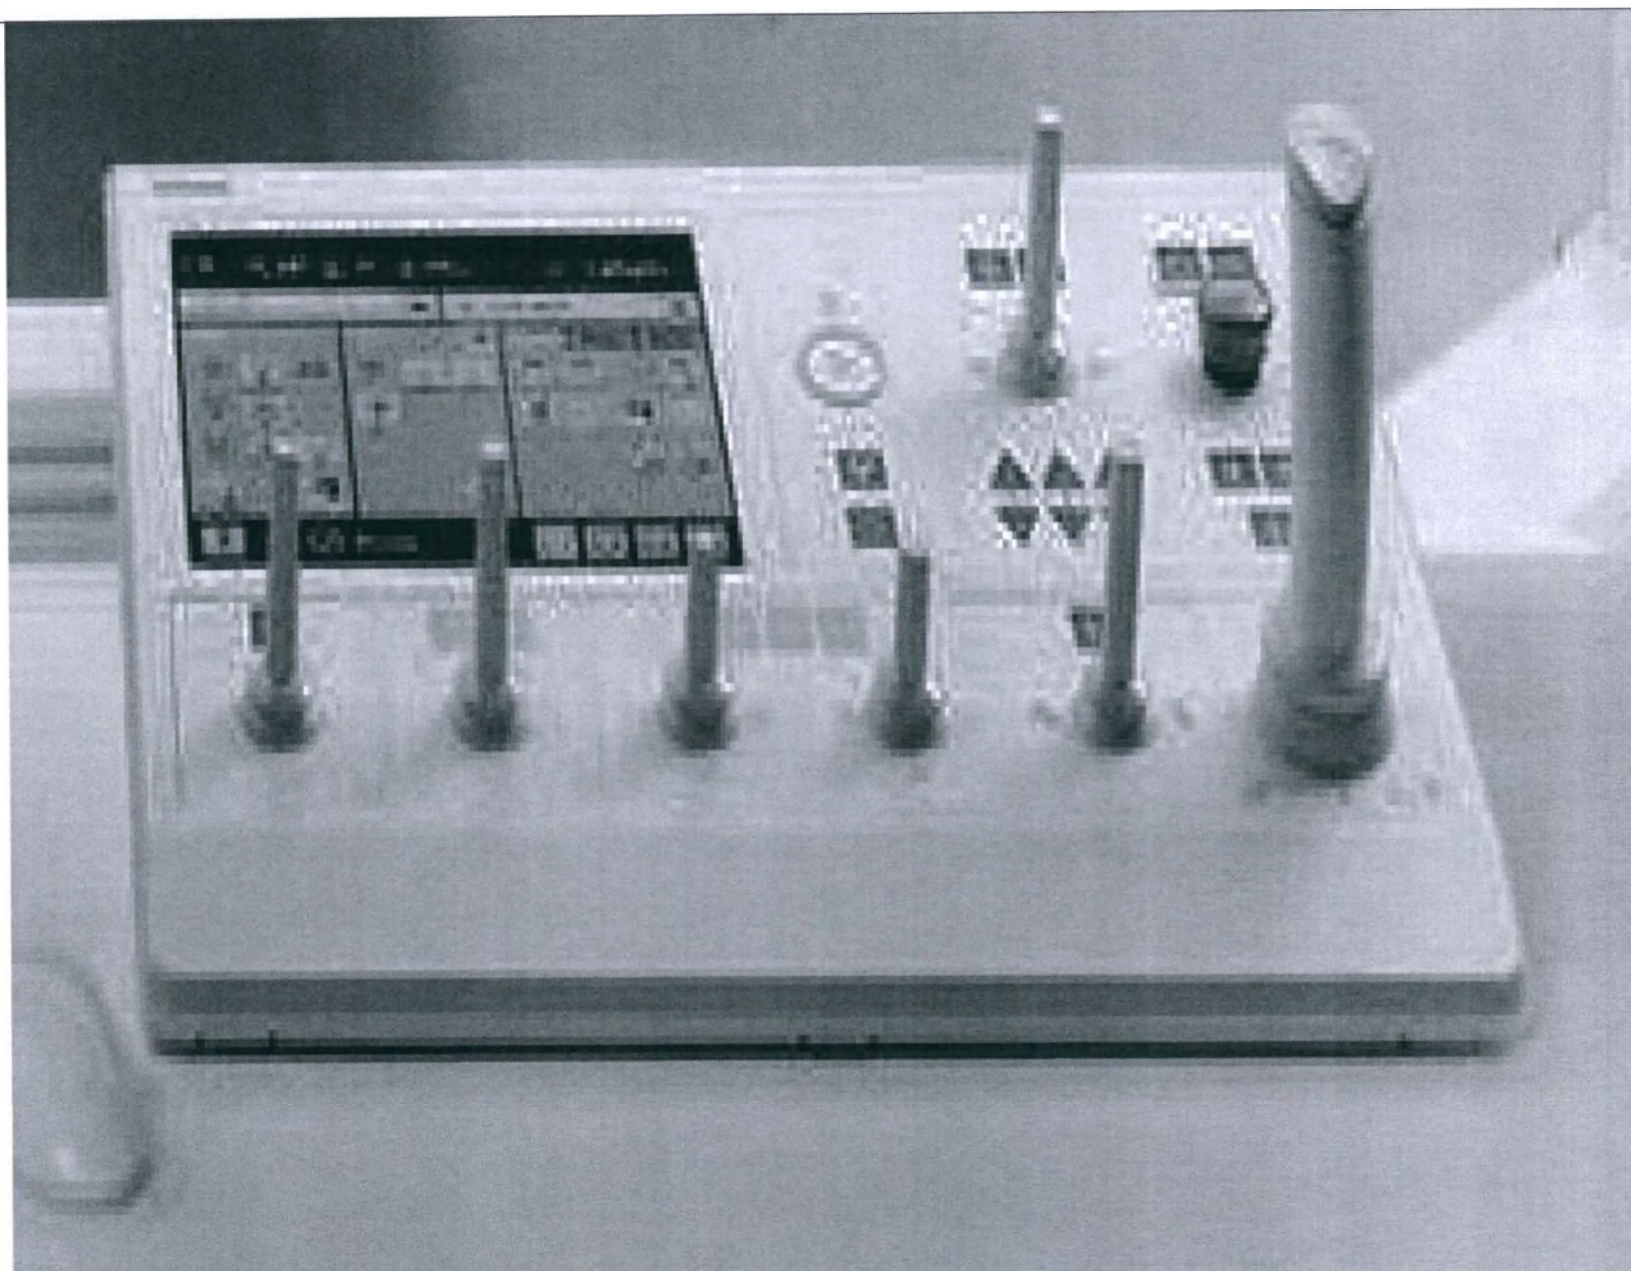


6. Дистанционный пульт управления системой.

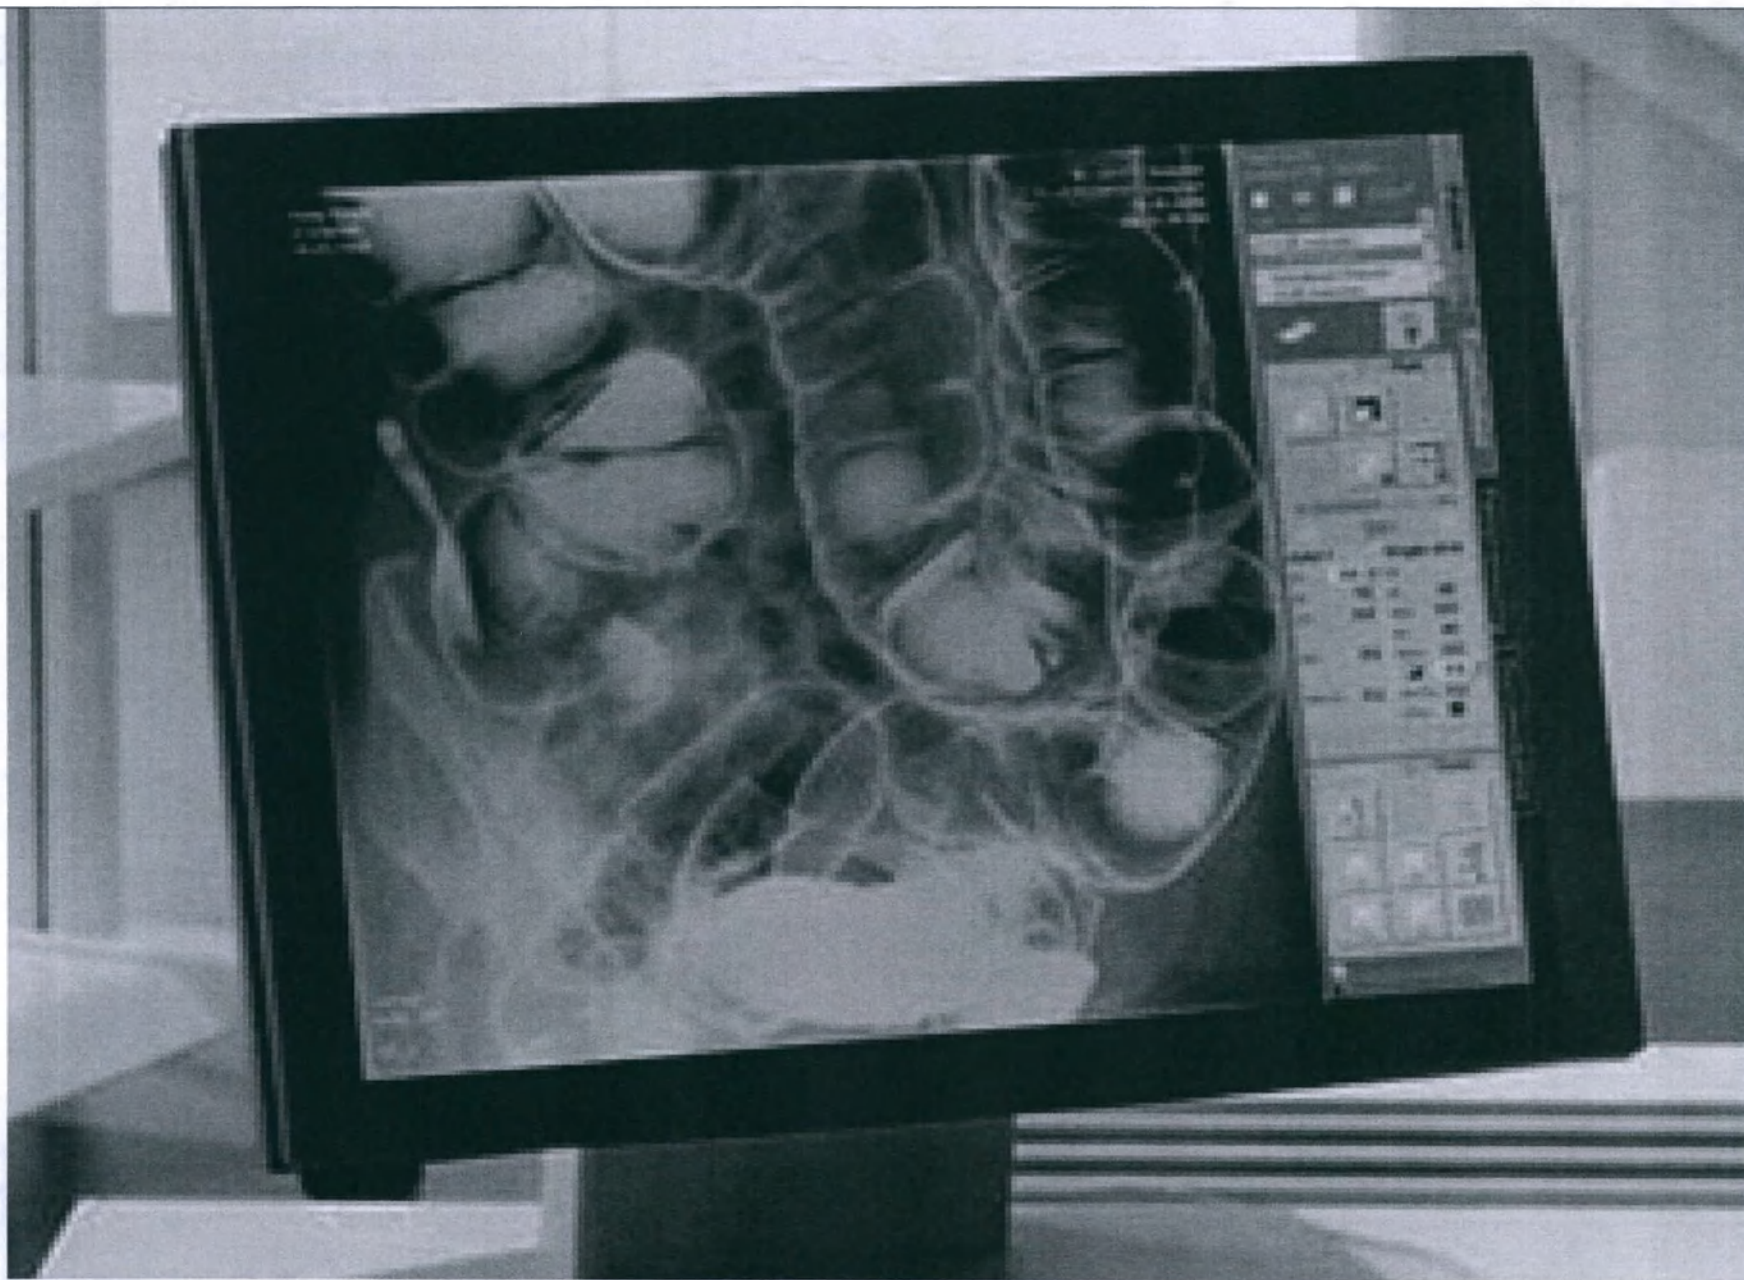


7. Дисплей для пультовой.



8.1 Система формирования изображений FLUOROSPOT Compact с базовым программным обеспечением, мышью и клавиатурой.

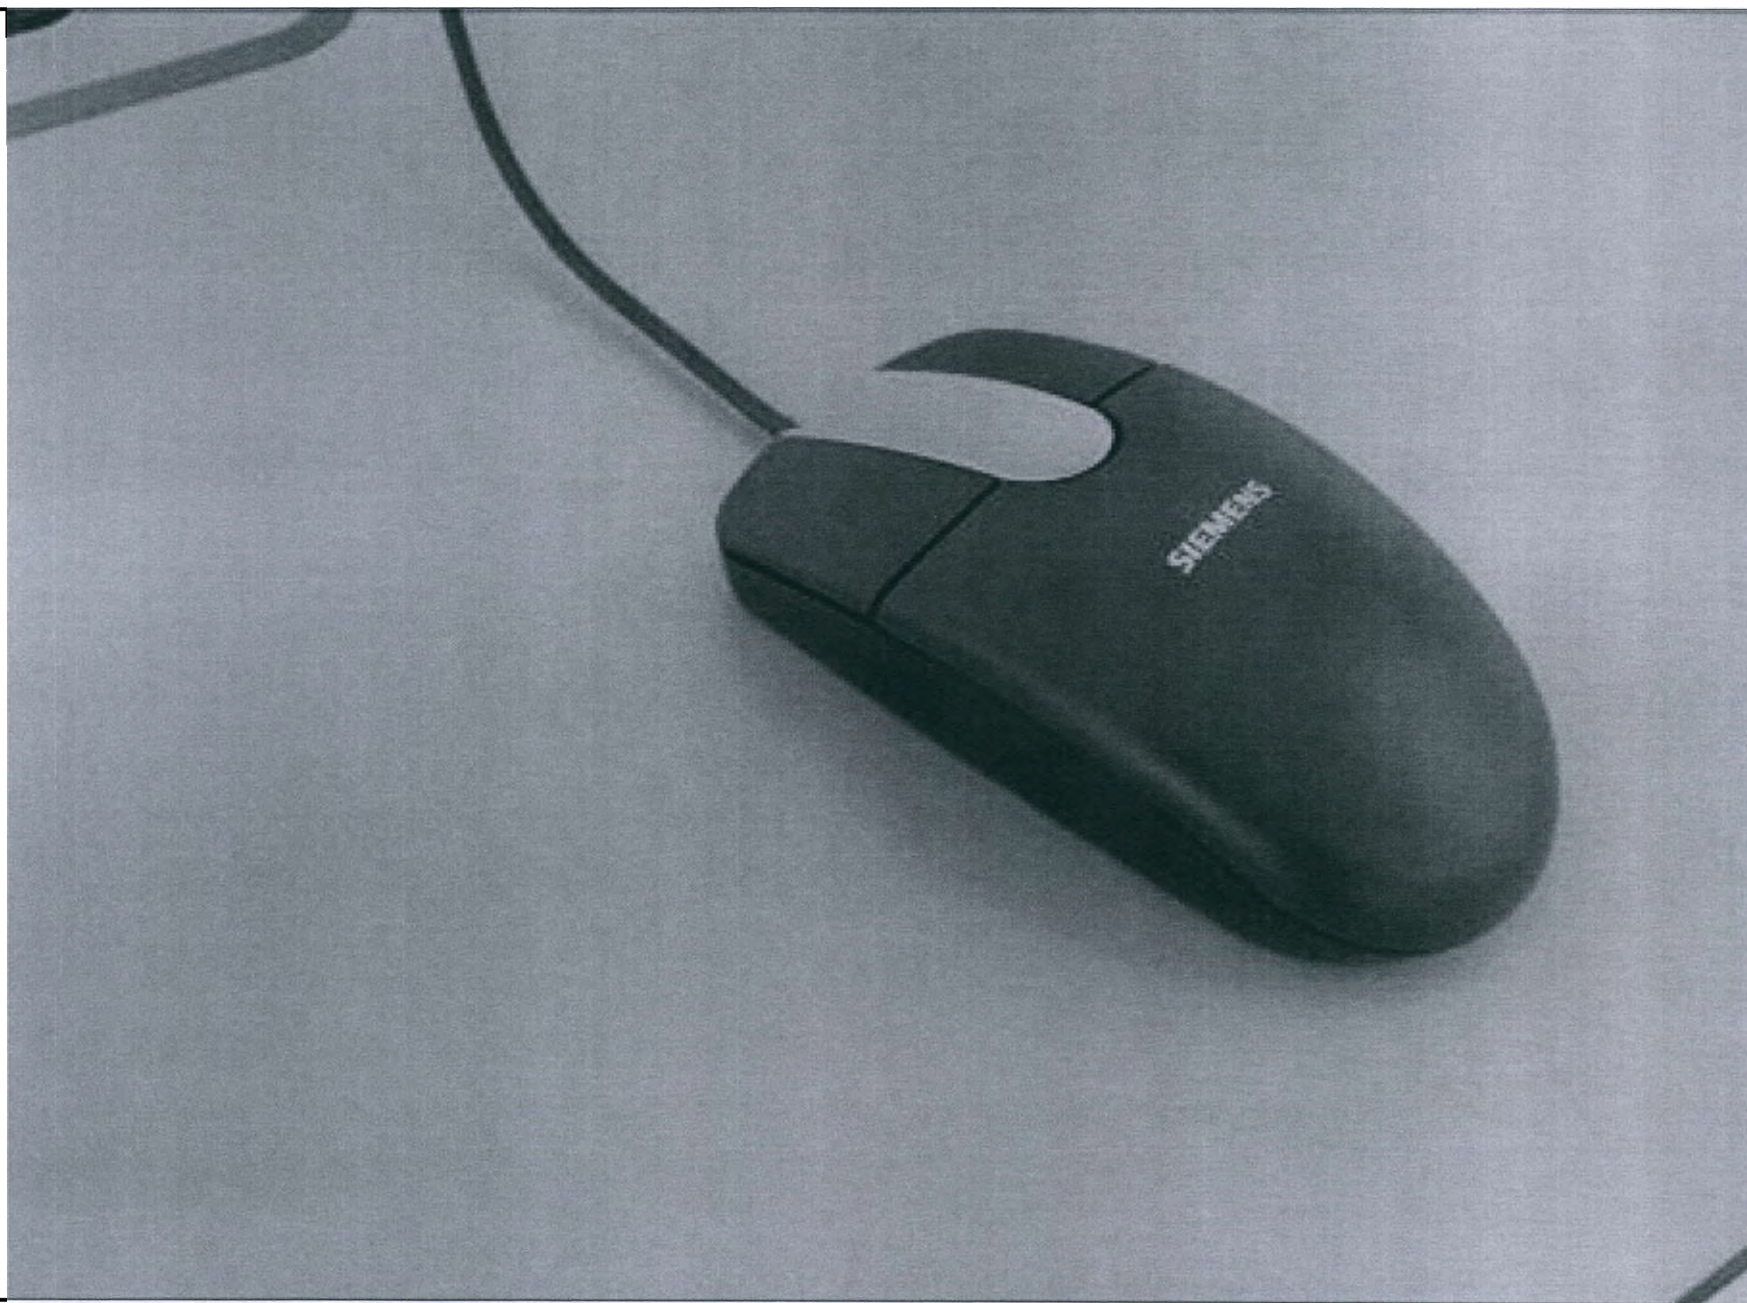


8.2 Система формирования изображений FLUOROSPOT Compact с базовым программным обеспечением, мышью и клавиатурой.

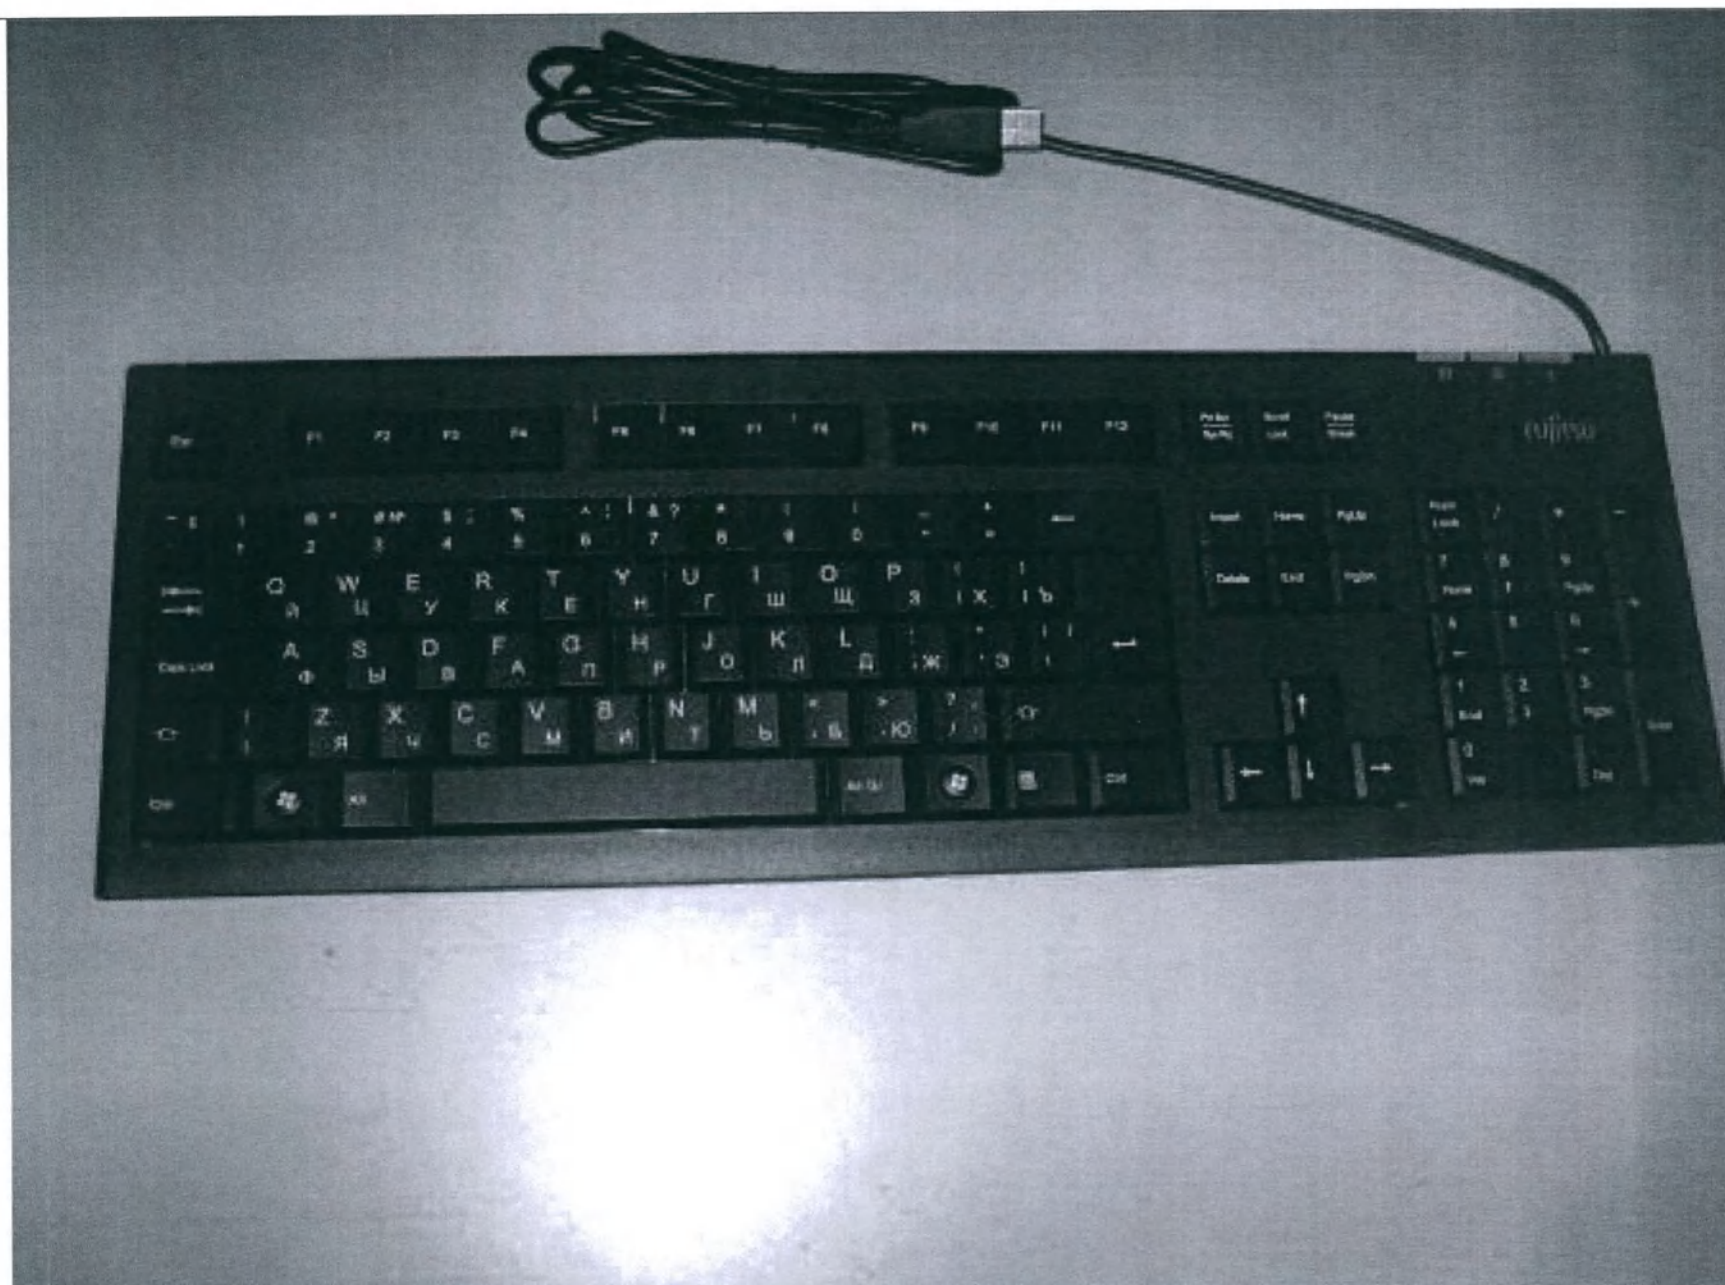


8.3 Система формирования изображений FLUOROSPOT Compact с базовым программным обеспечением, мышью и клавиатурой.




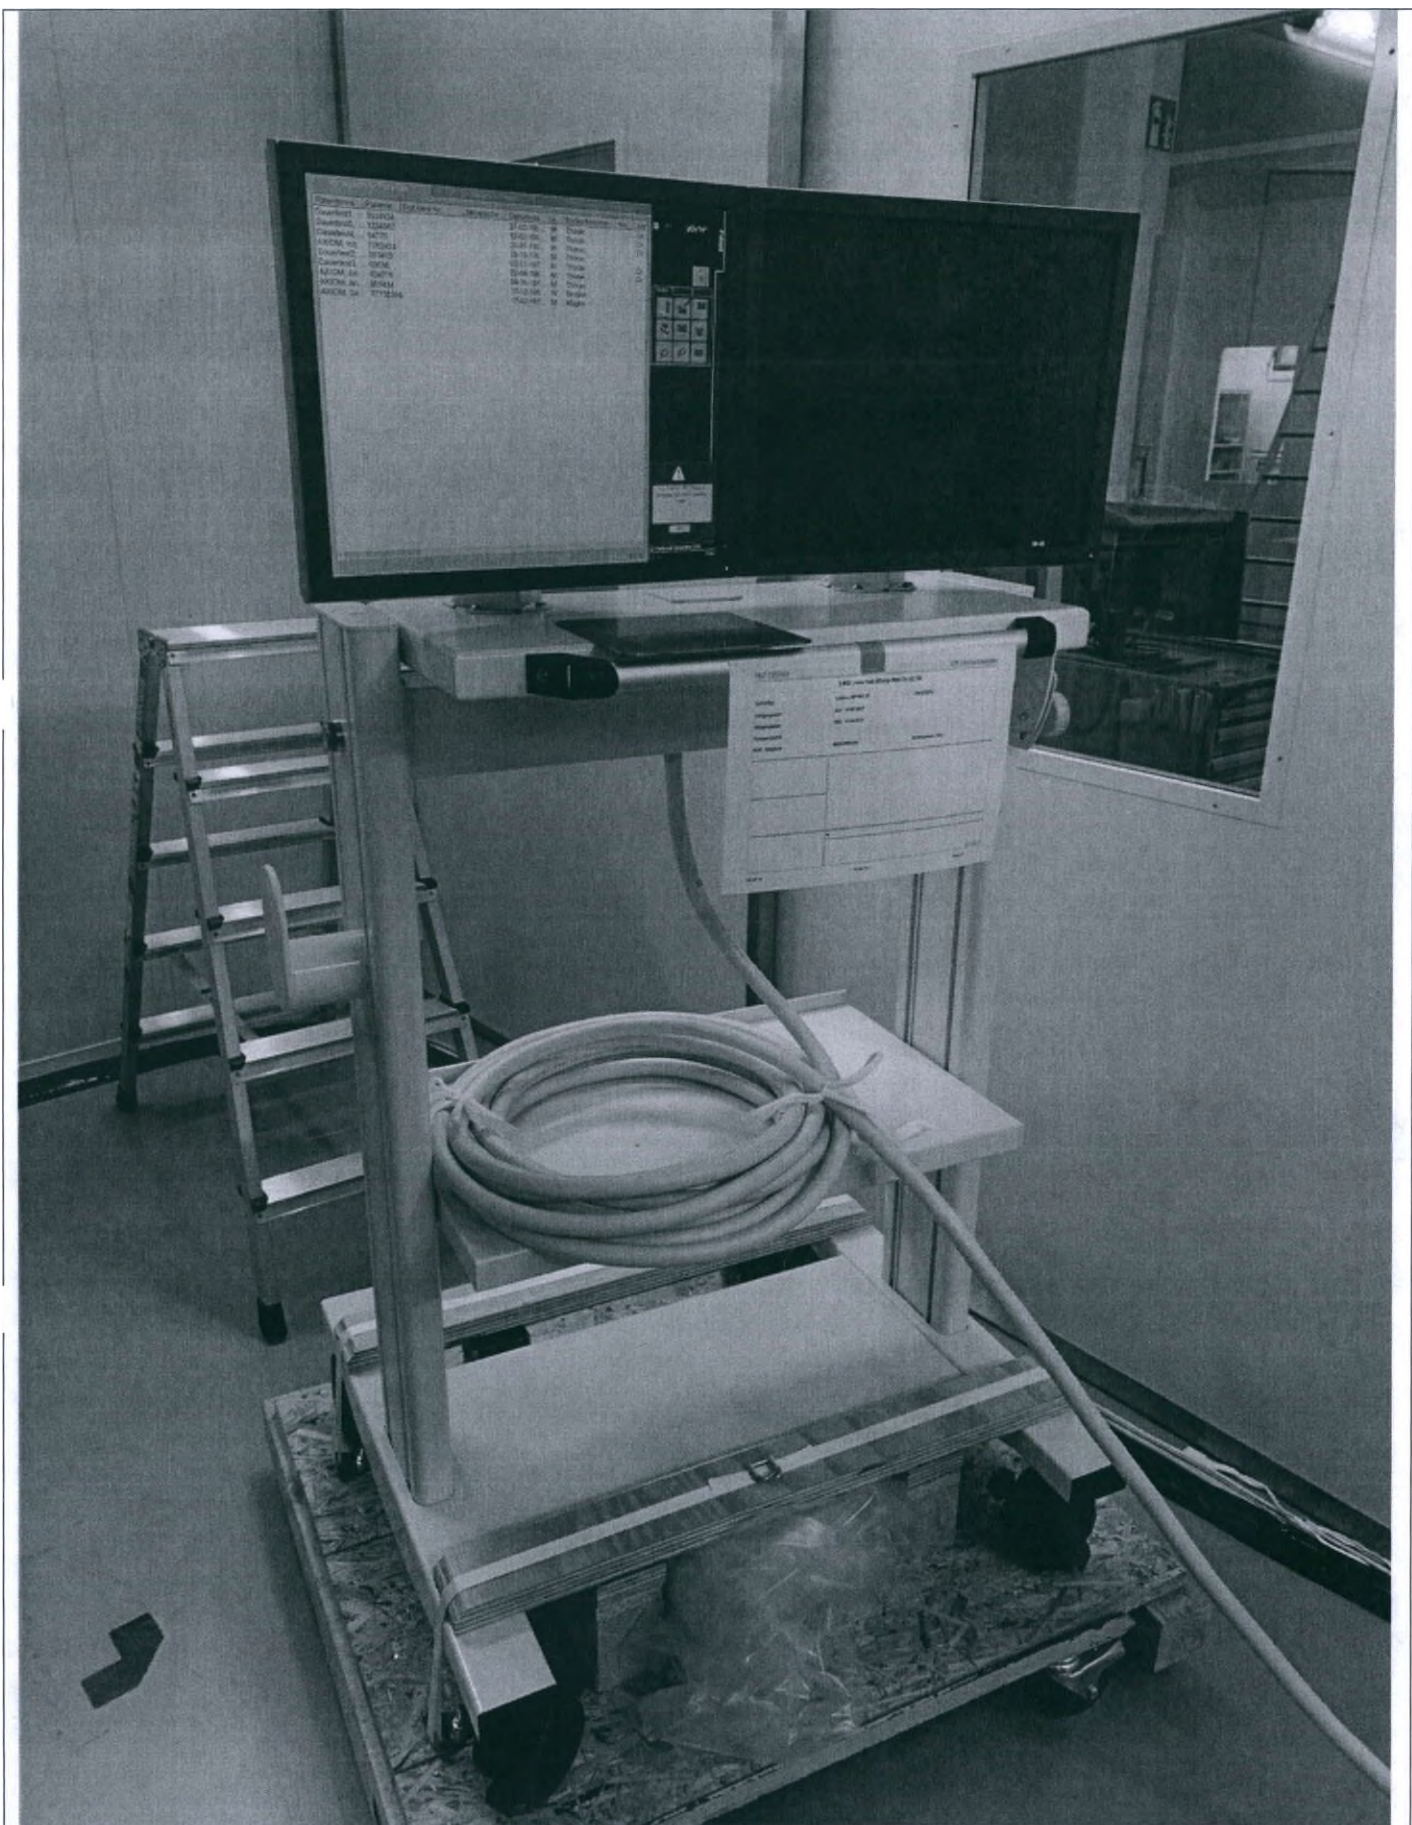

9.1 Тележка с одним или двумя дисплеями

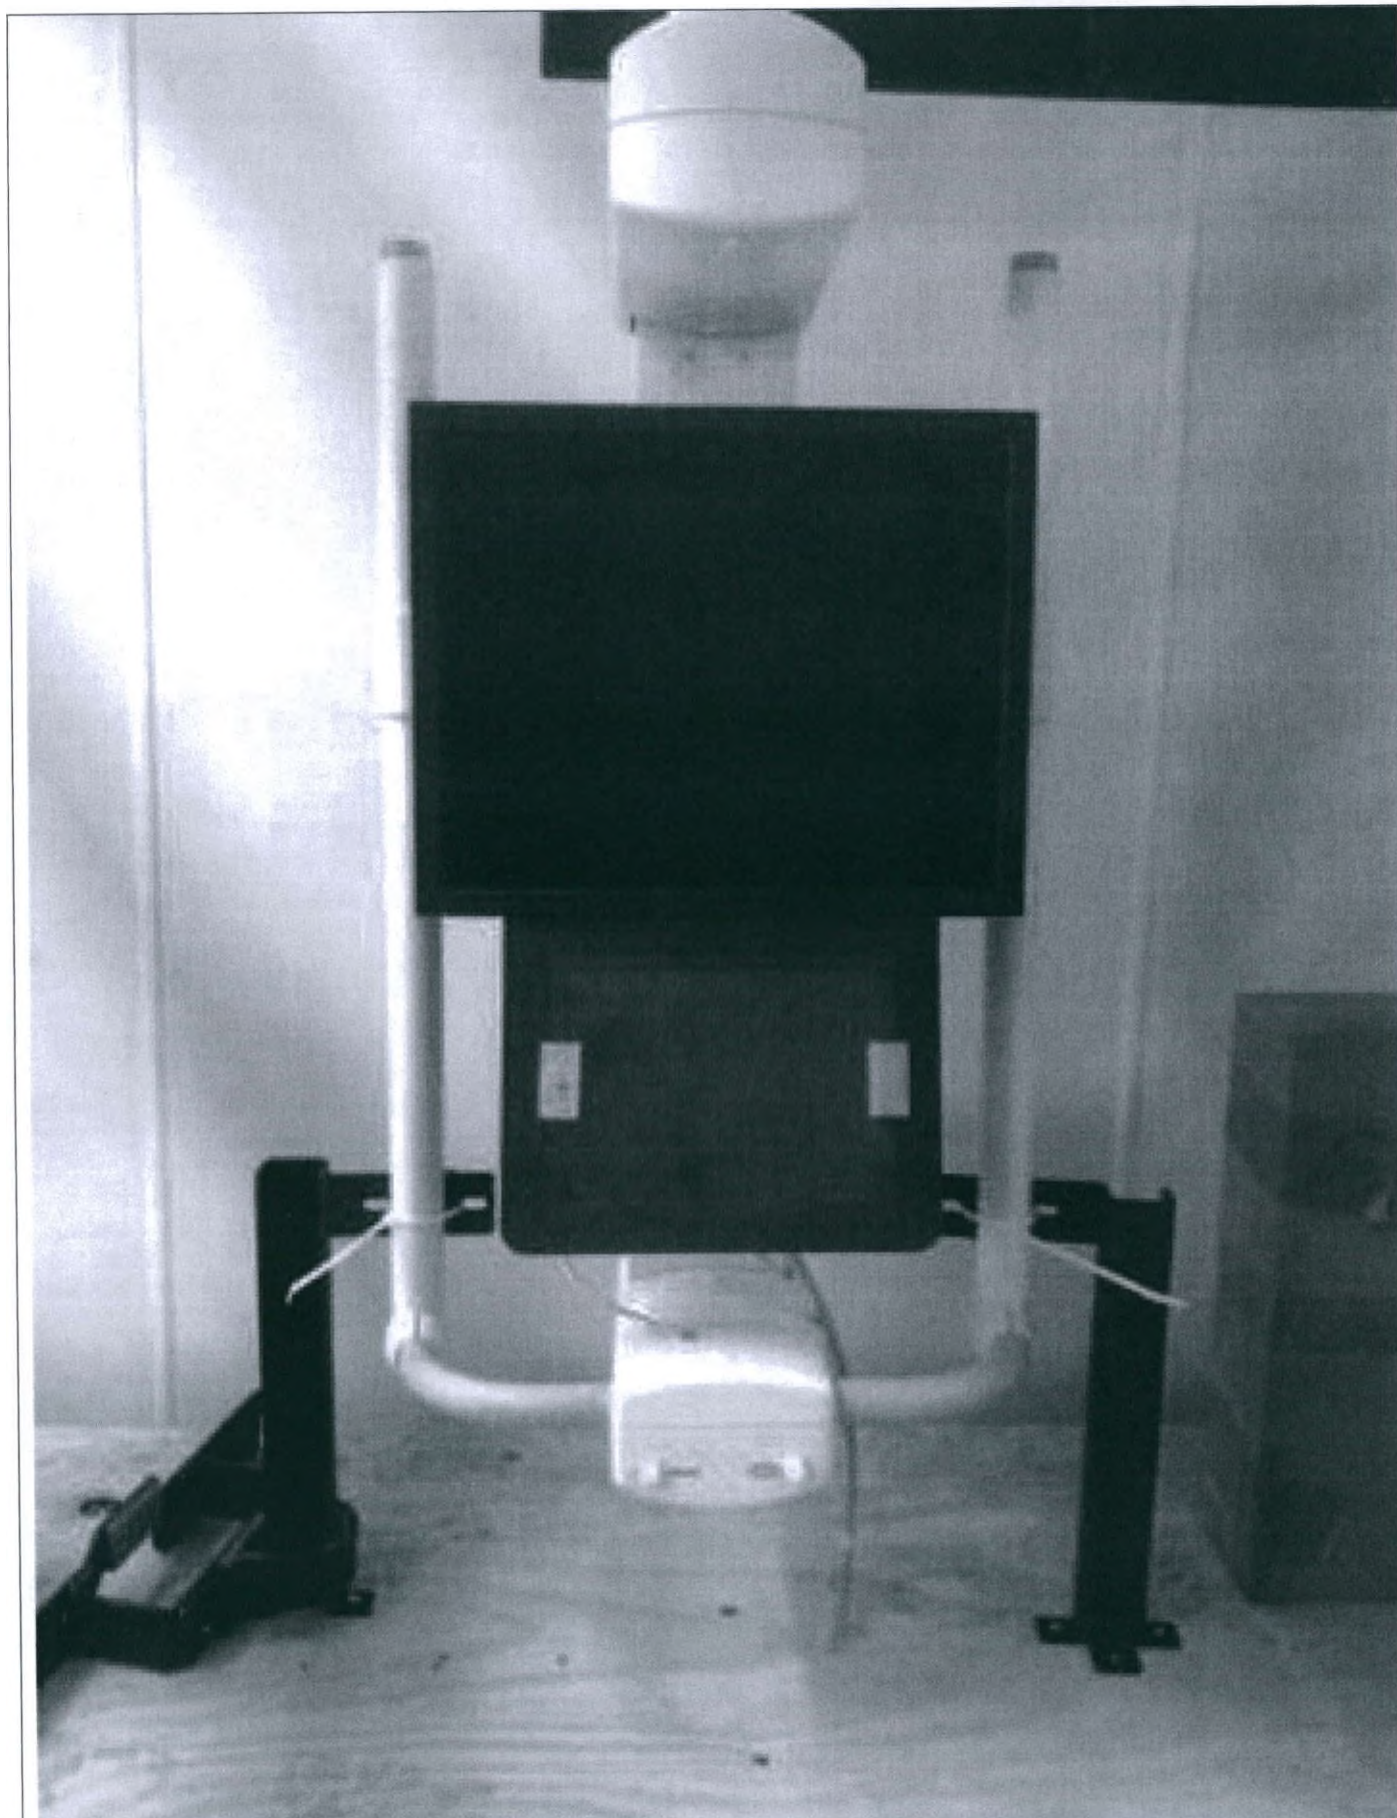


9.2 Потолочная подвеска с одним или двумя дисплеями.

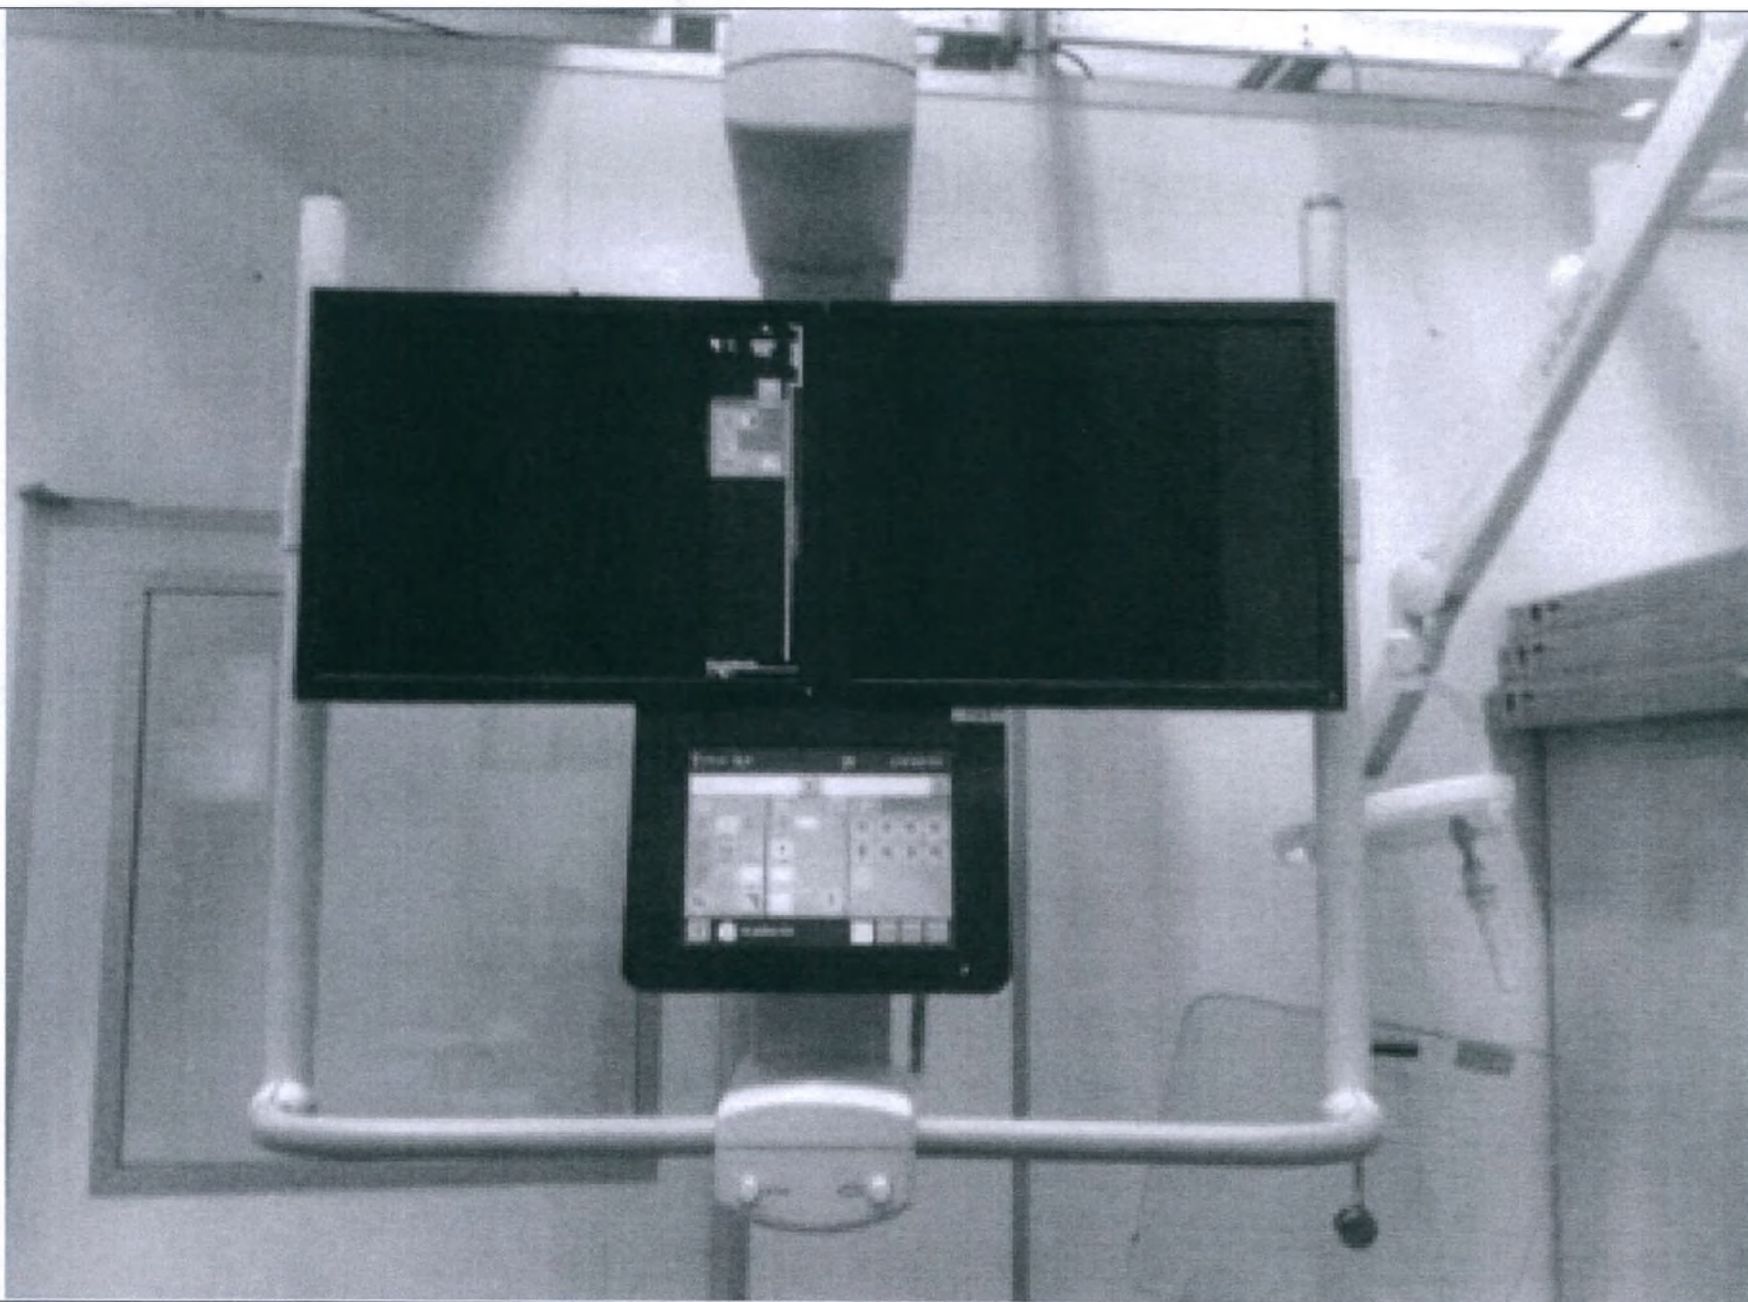


9.3 Потолочная подвеска с одним или двумя дисплеями




10. Педальный переключатель для рентгеноскопии и рентгенографии.

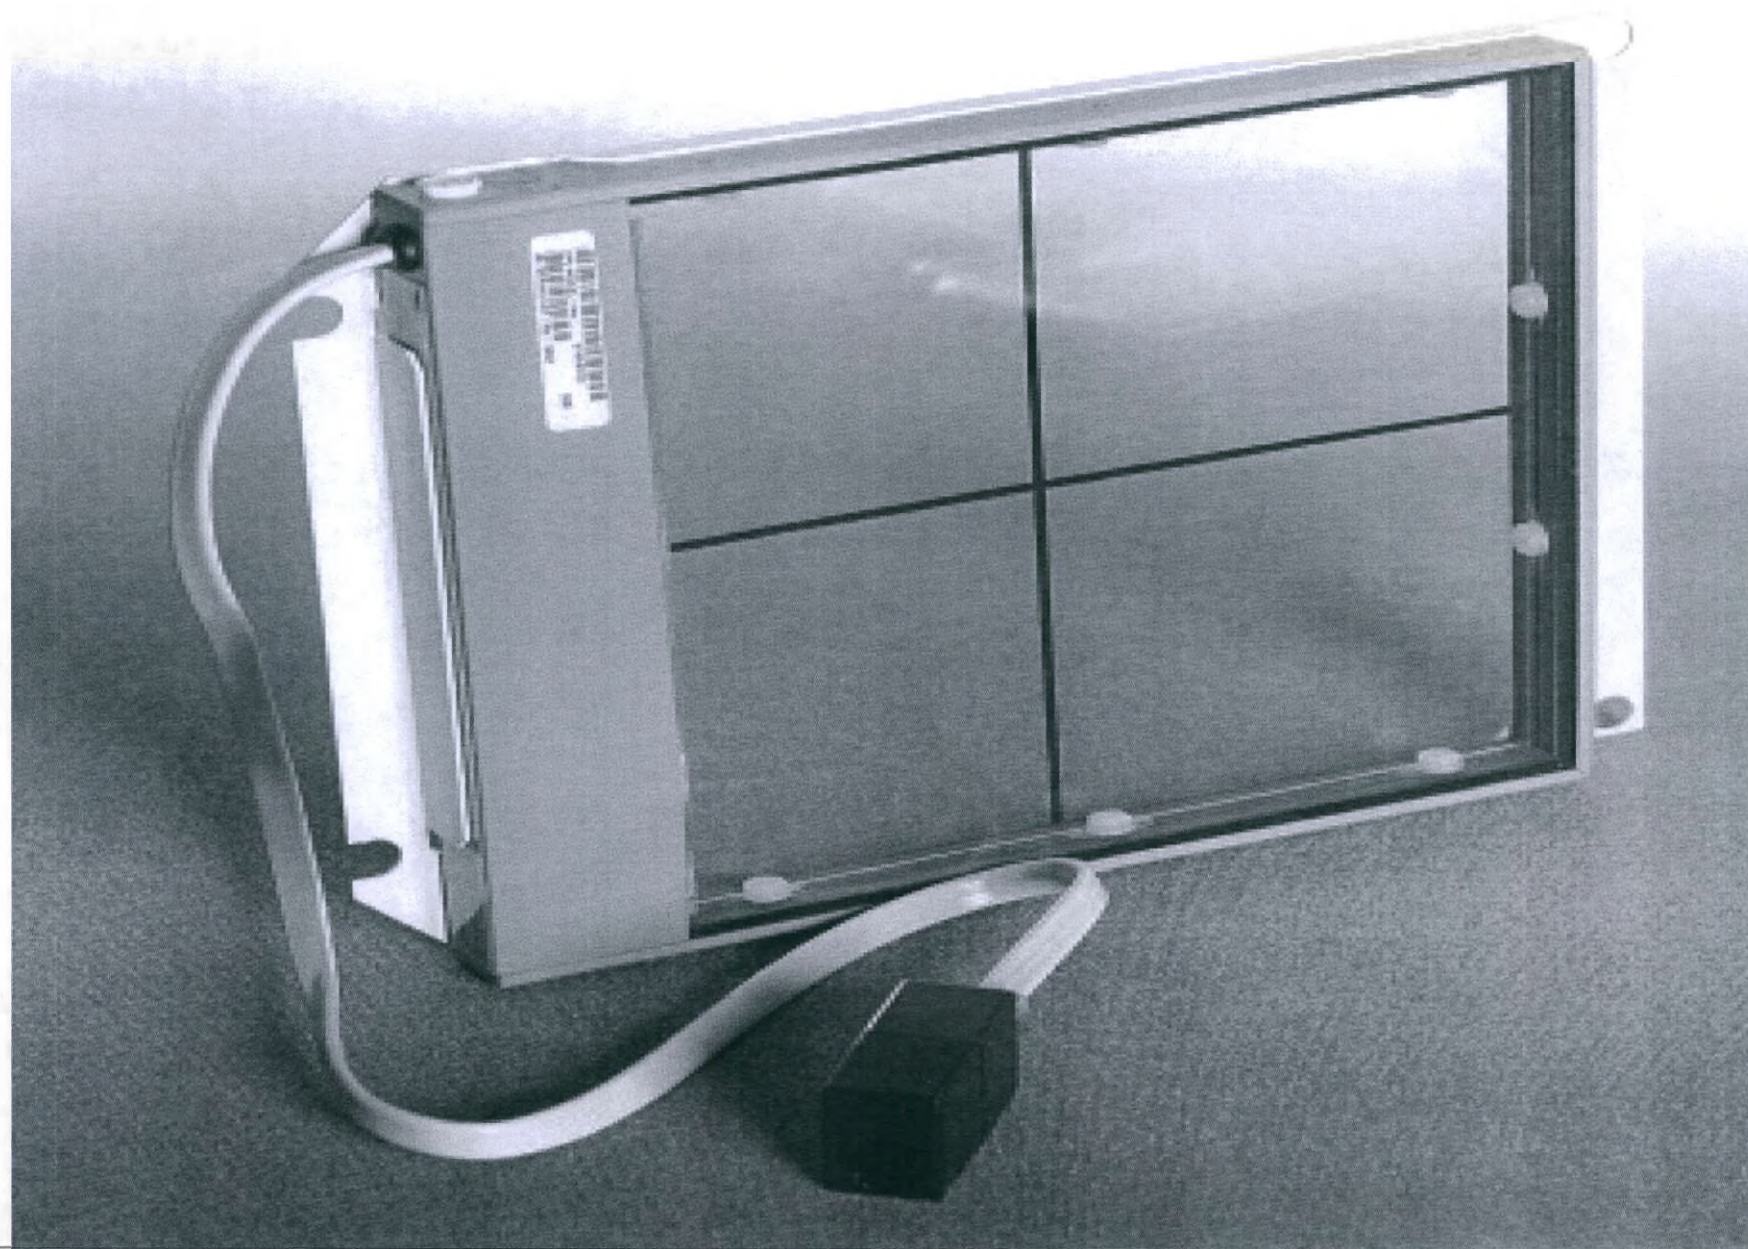

11. Устройство измерения суммарной поверхностной дозы.

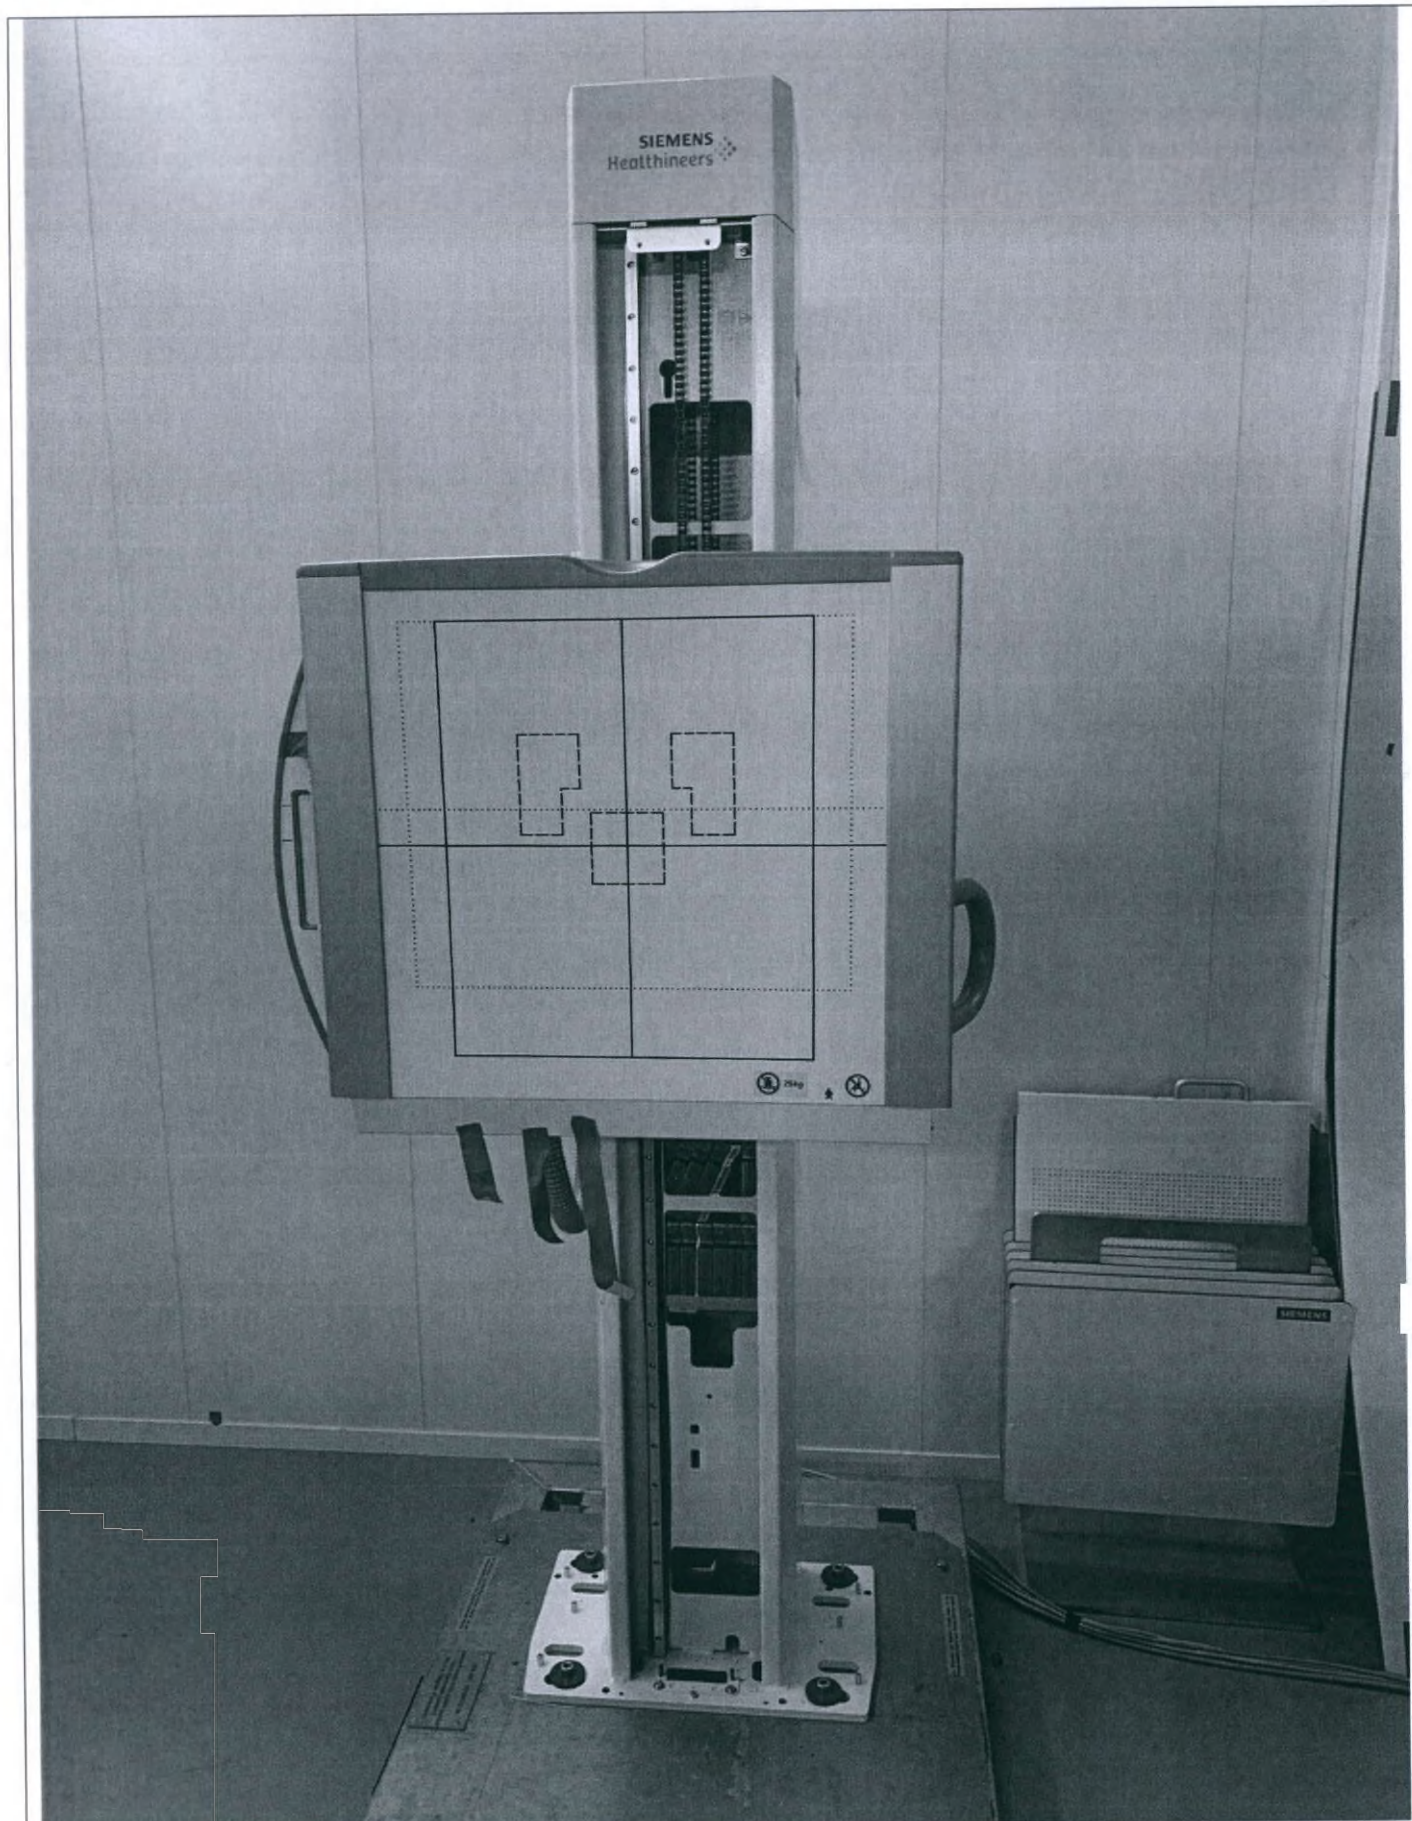

12. Вертикальная стойка, варианты исполнения:
- с плоским стационарным детектором;
- для беспроводного детектора

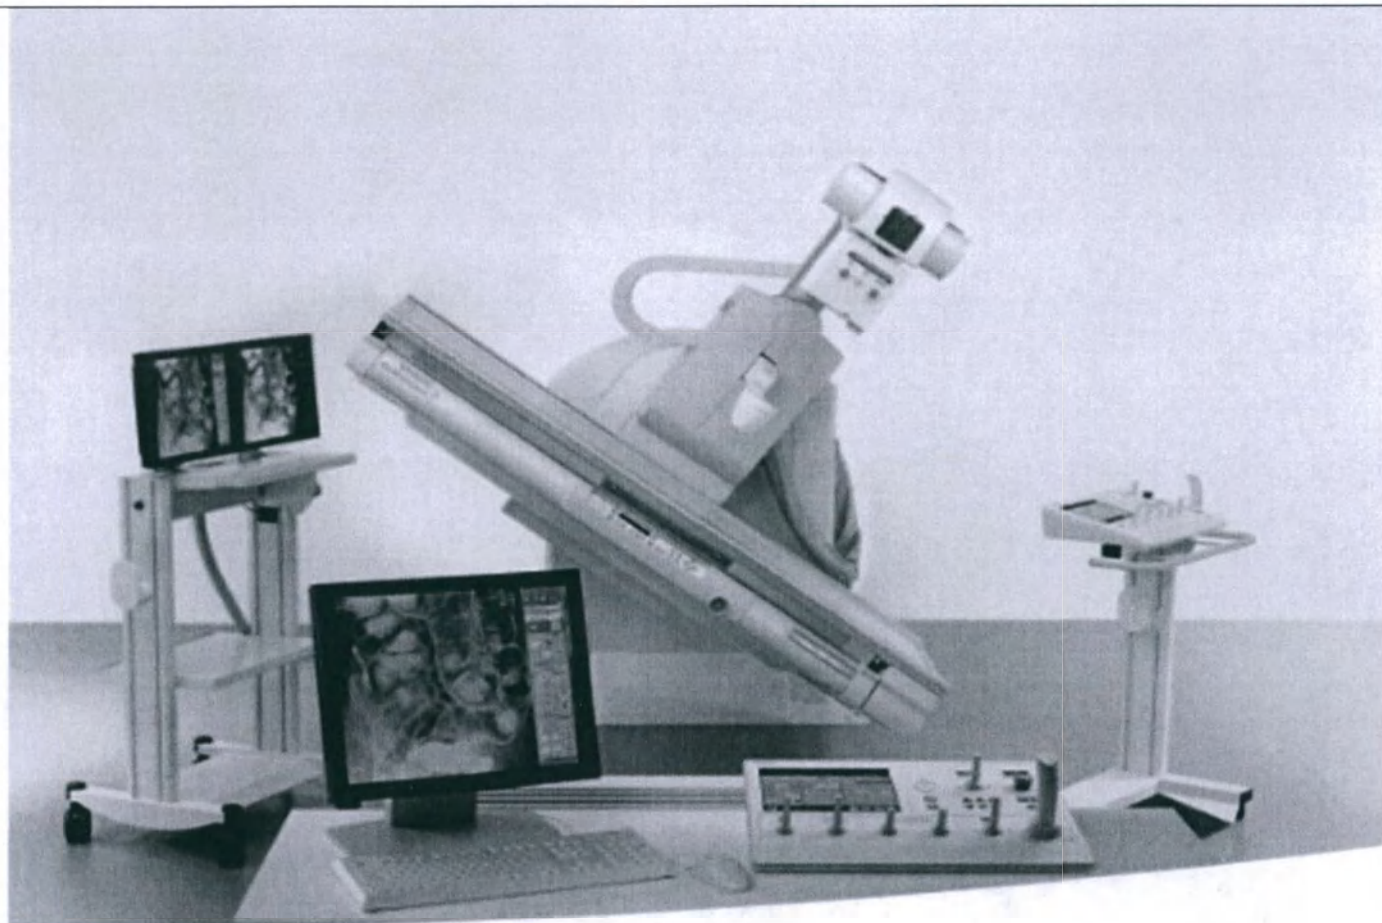


Luminos dRF Max

Руководство пользователя – VF11 и более поздние версии

siemens-healthineers.com


SIEMENS
Healthineers

13. Документация пользователя на русском языке

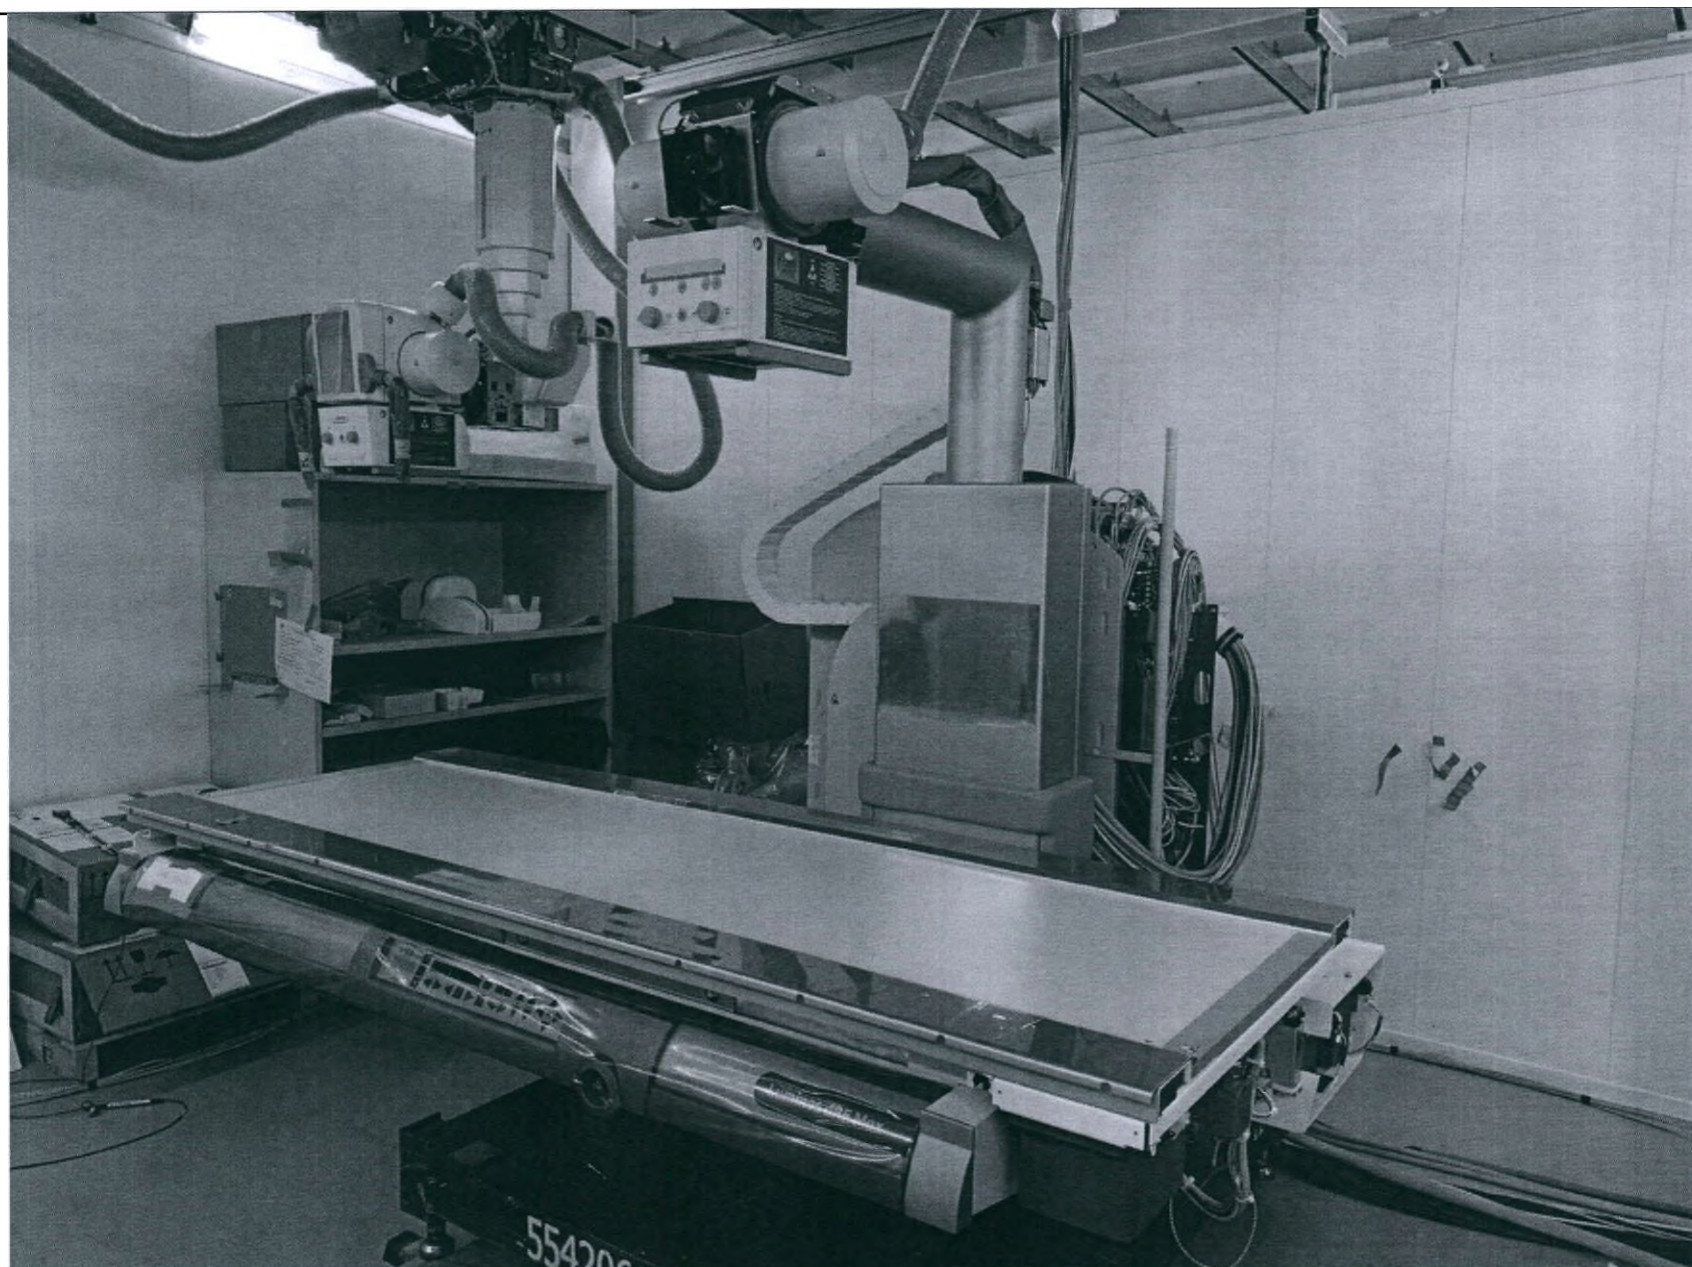


1. Теплеуправляемый стол-штатив Luminos dRF Max


3. Базовый блок, вариант 3.

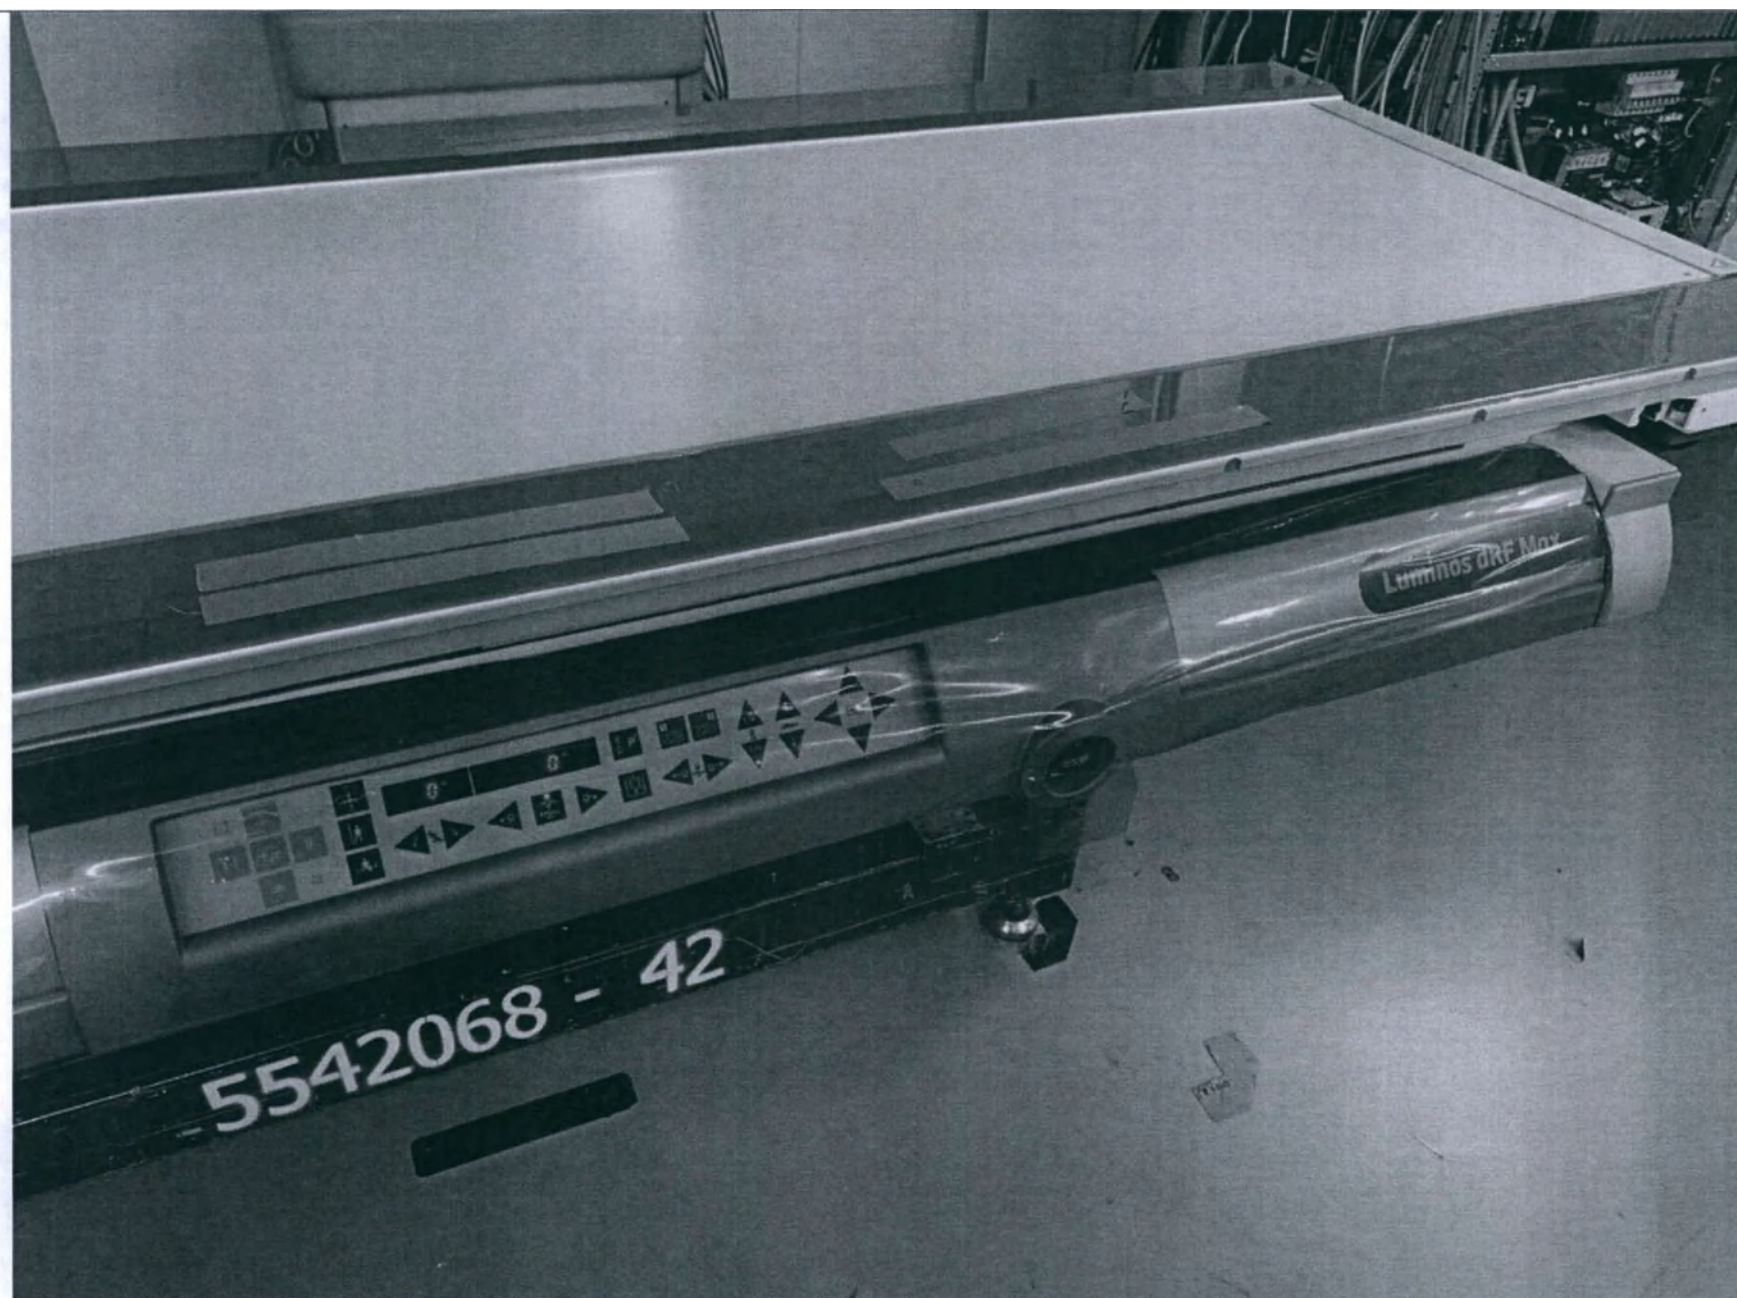


2.1 Плоский детектор.

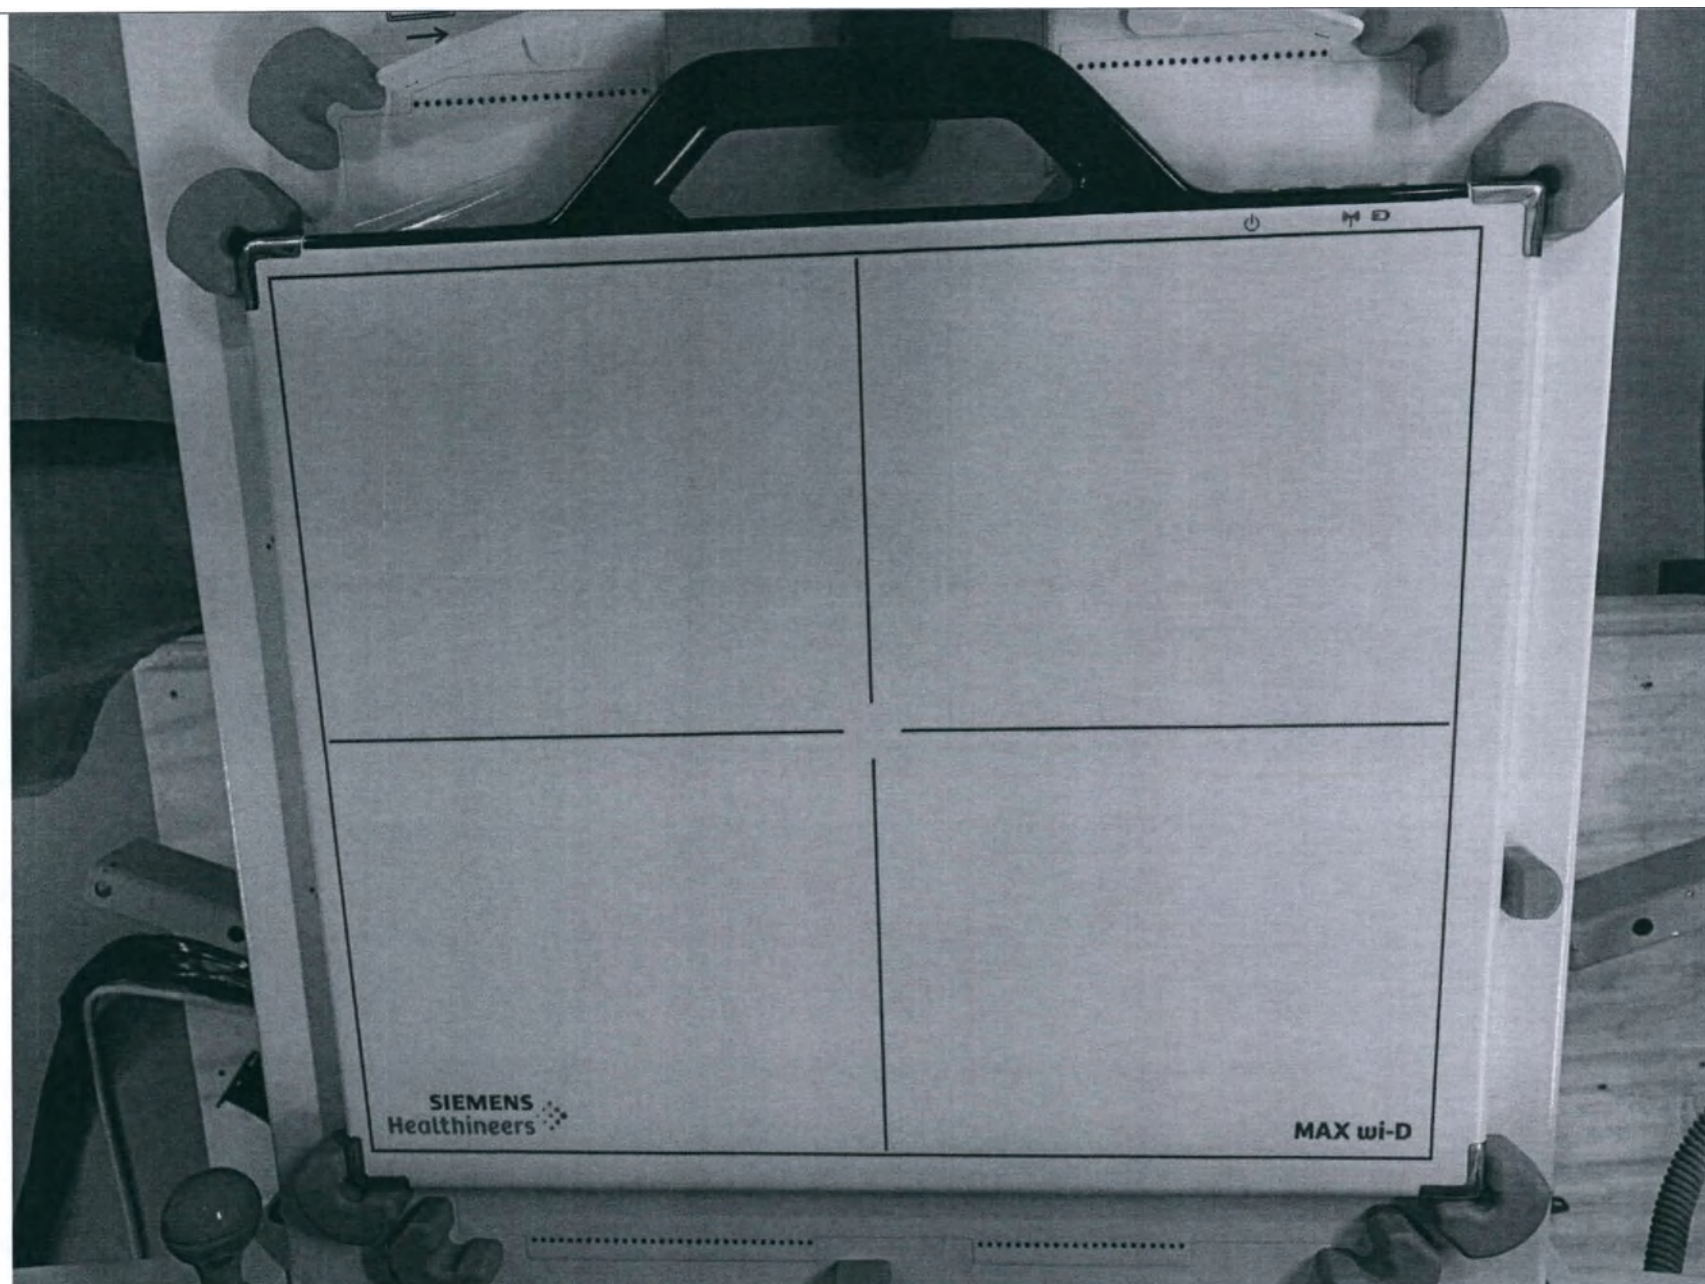


2.2 Беспроводной детектор MAX wi-D.

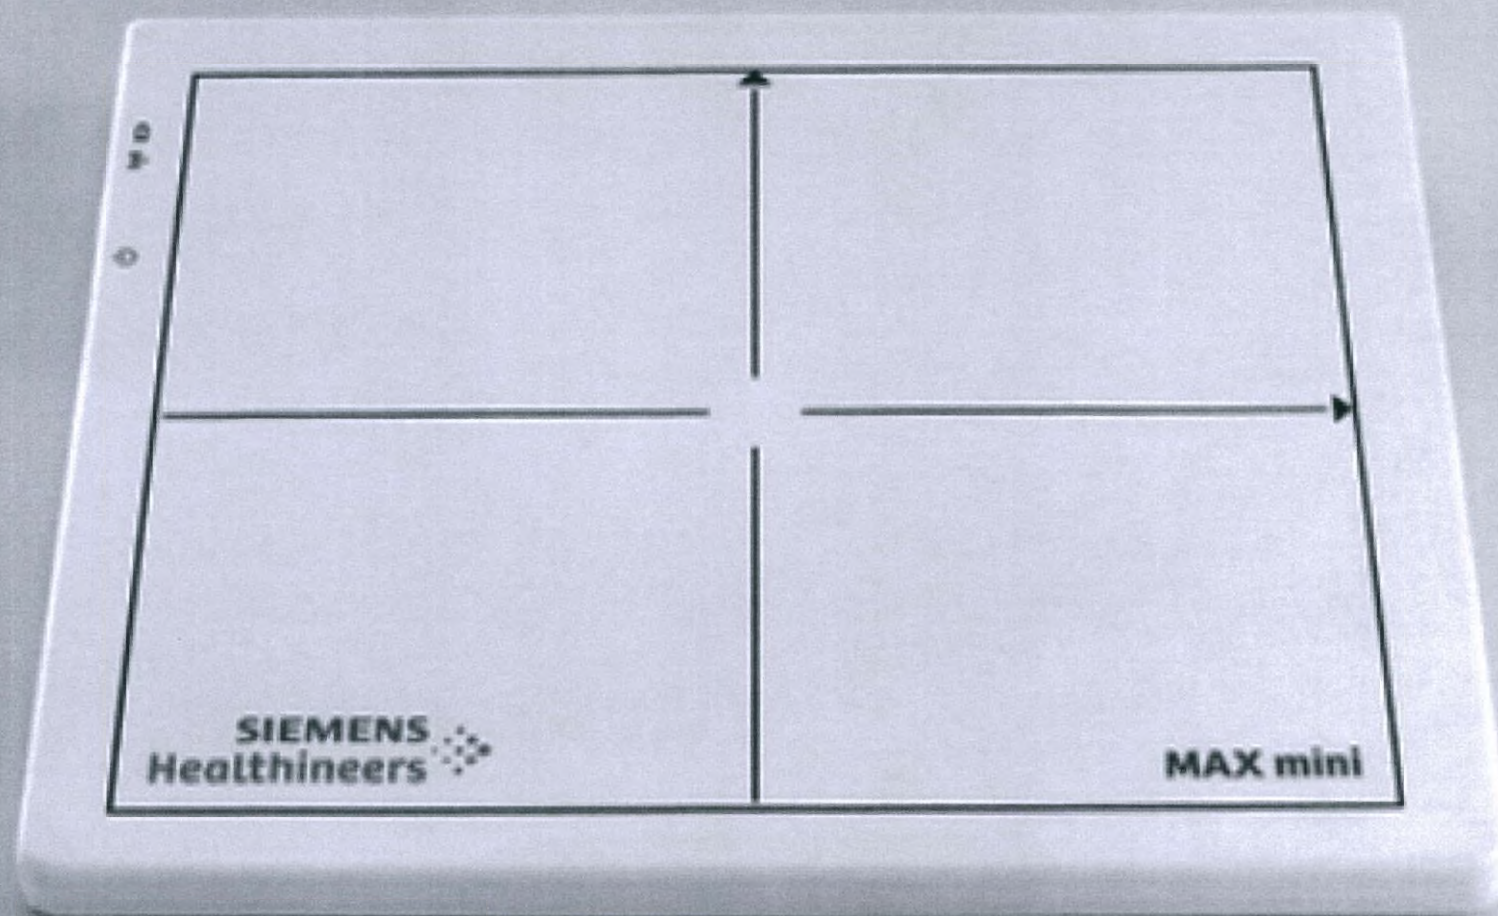


2.3 Беспроводной детектор MAX mini.

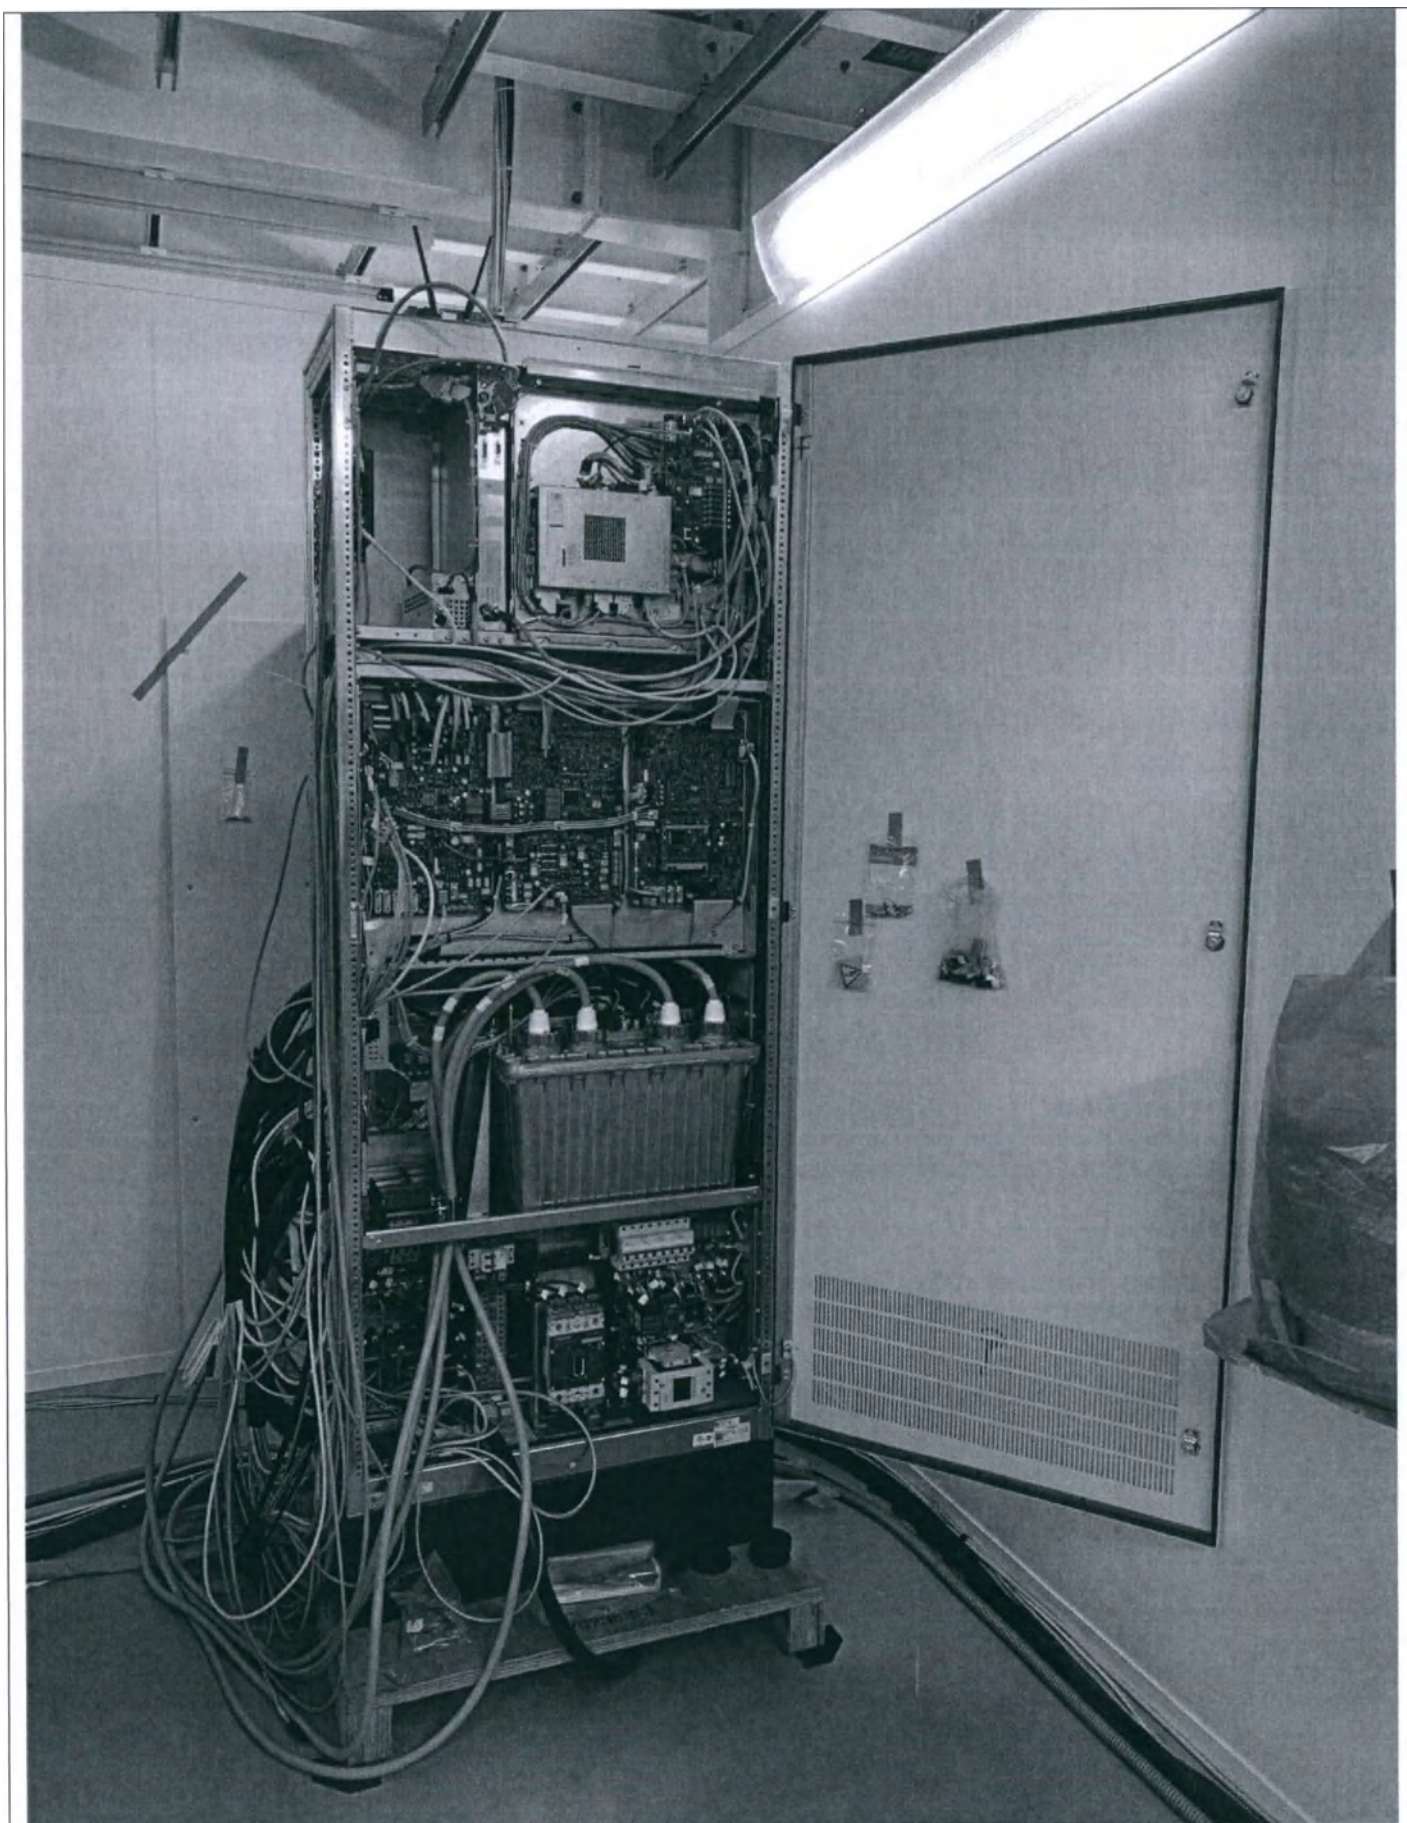


3. Генератор рентгеновский POLYDOROS F (варианты исполнения 65 кВт, 80 кВт)

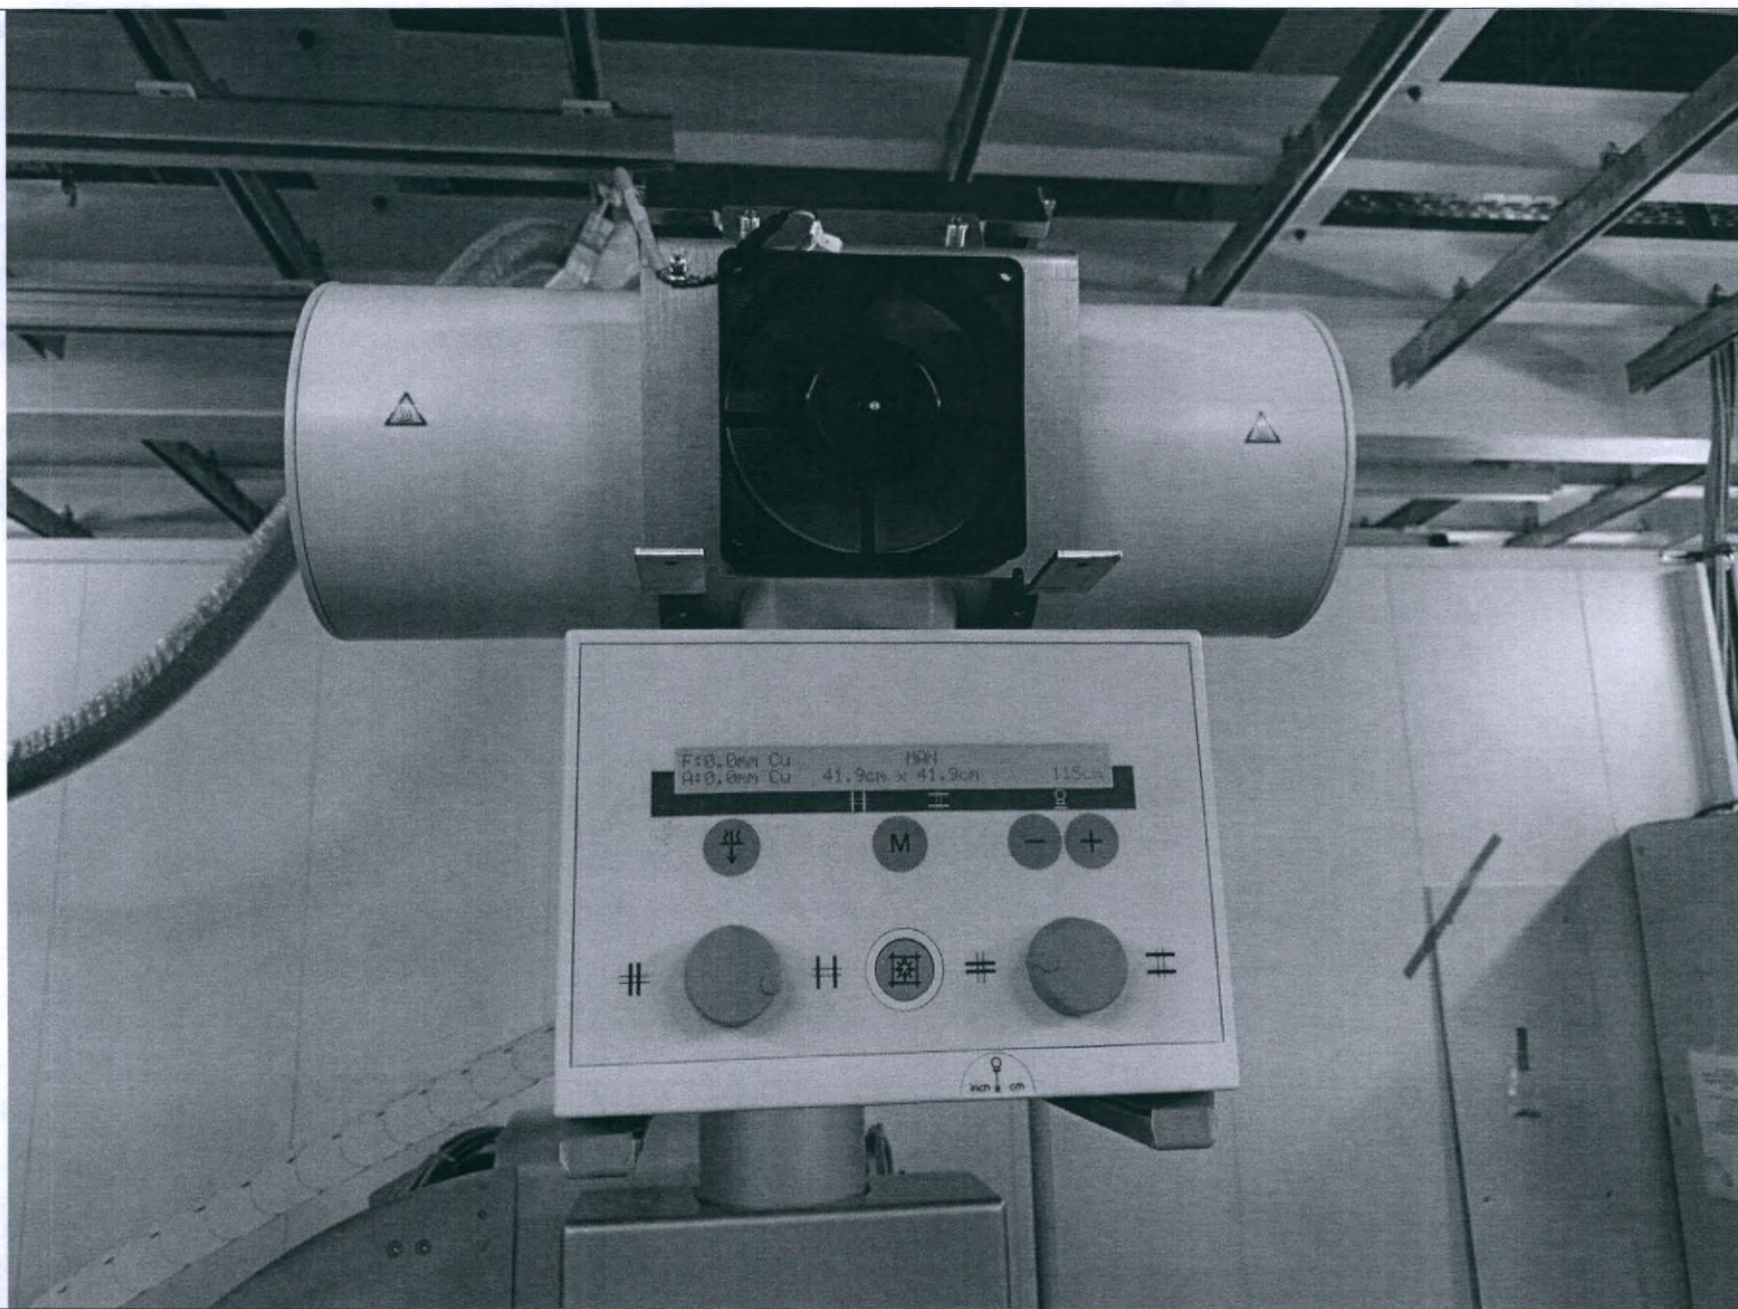


4. Рентгеновская трубка OPTITOR.

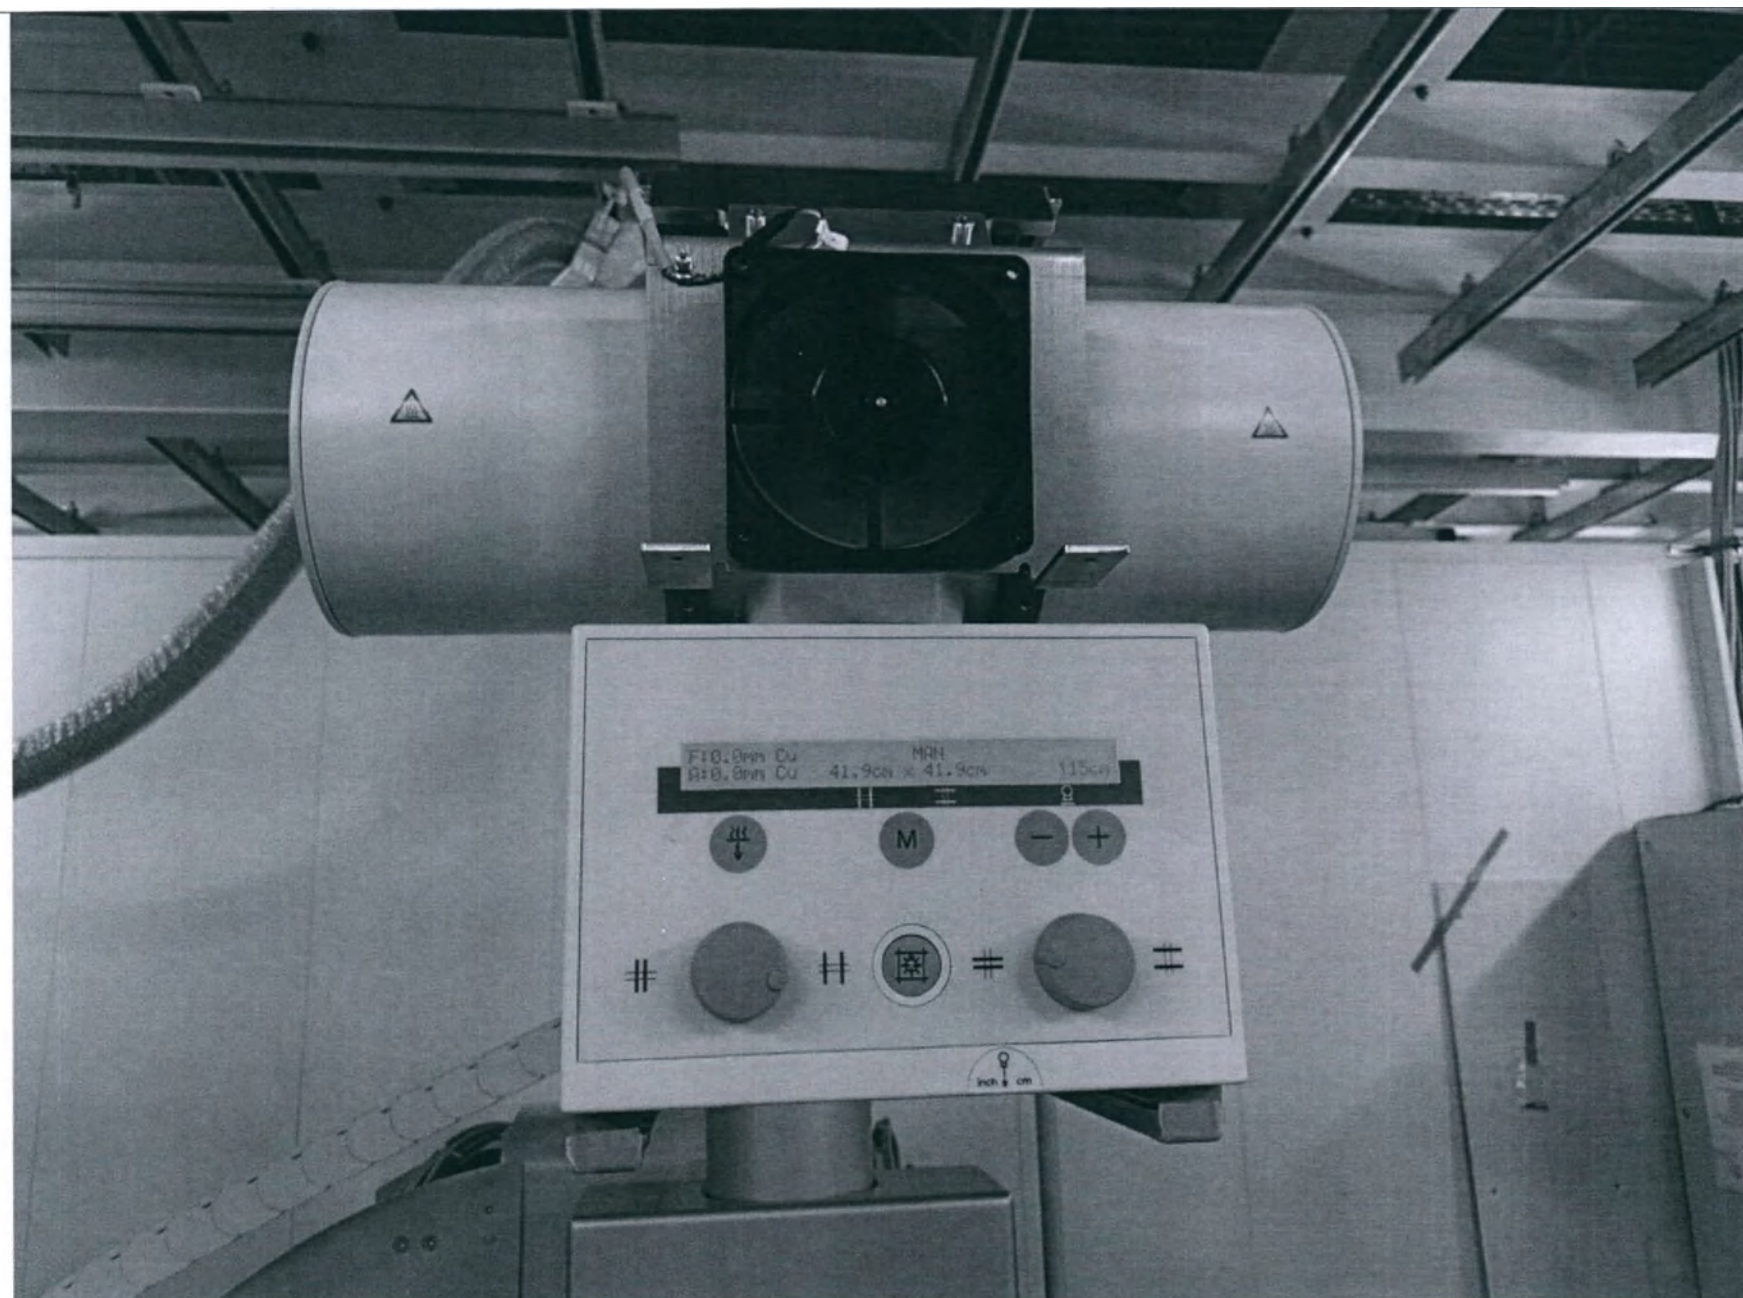

5. Многолепестковый коллиматор, варианты исполнения: - стандартный; - с полупрозрачными фильтрами.

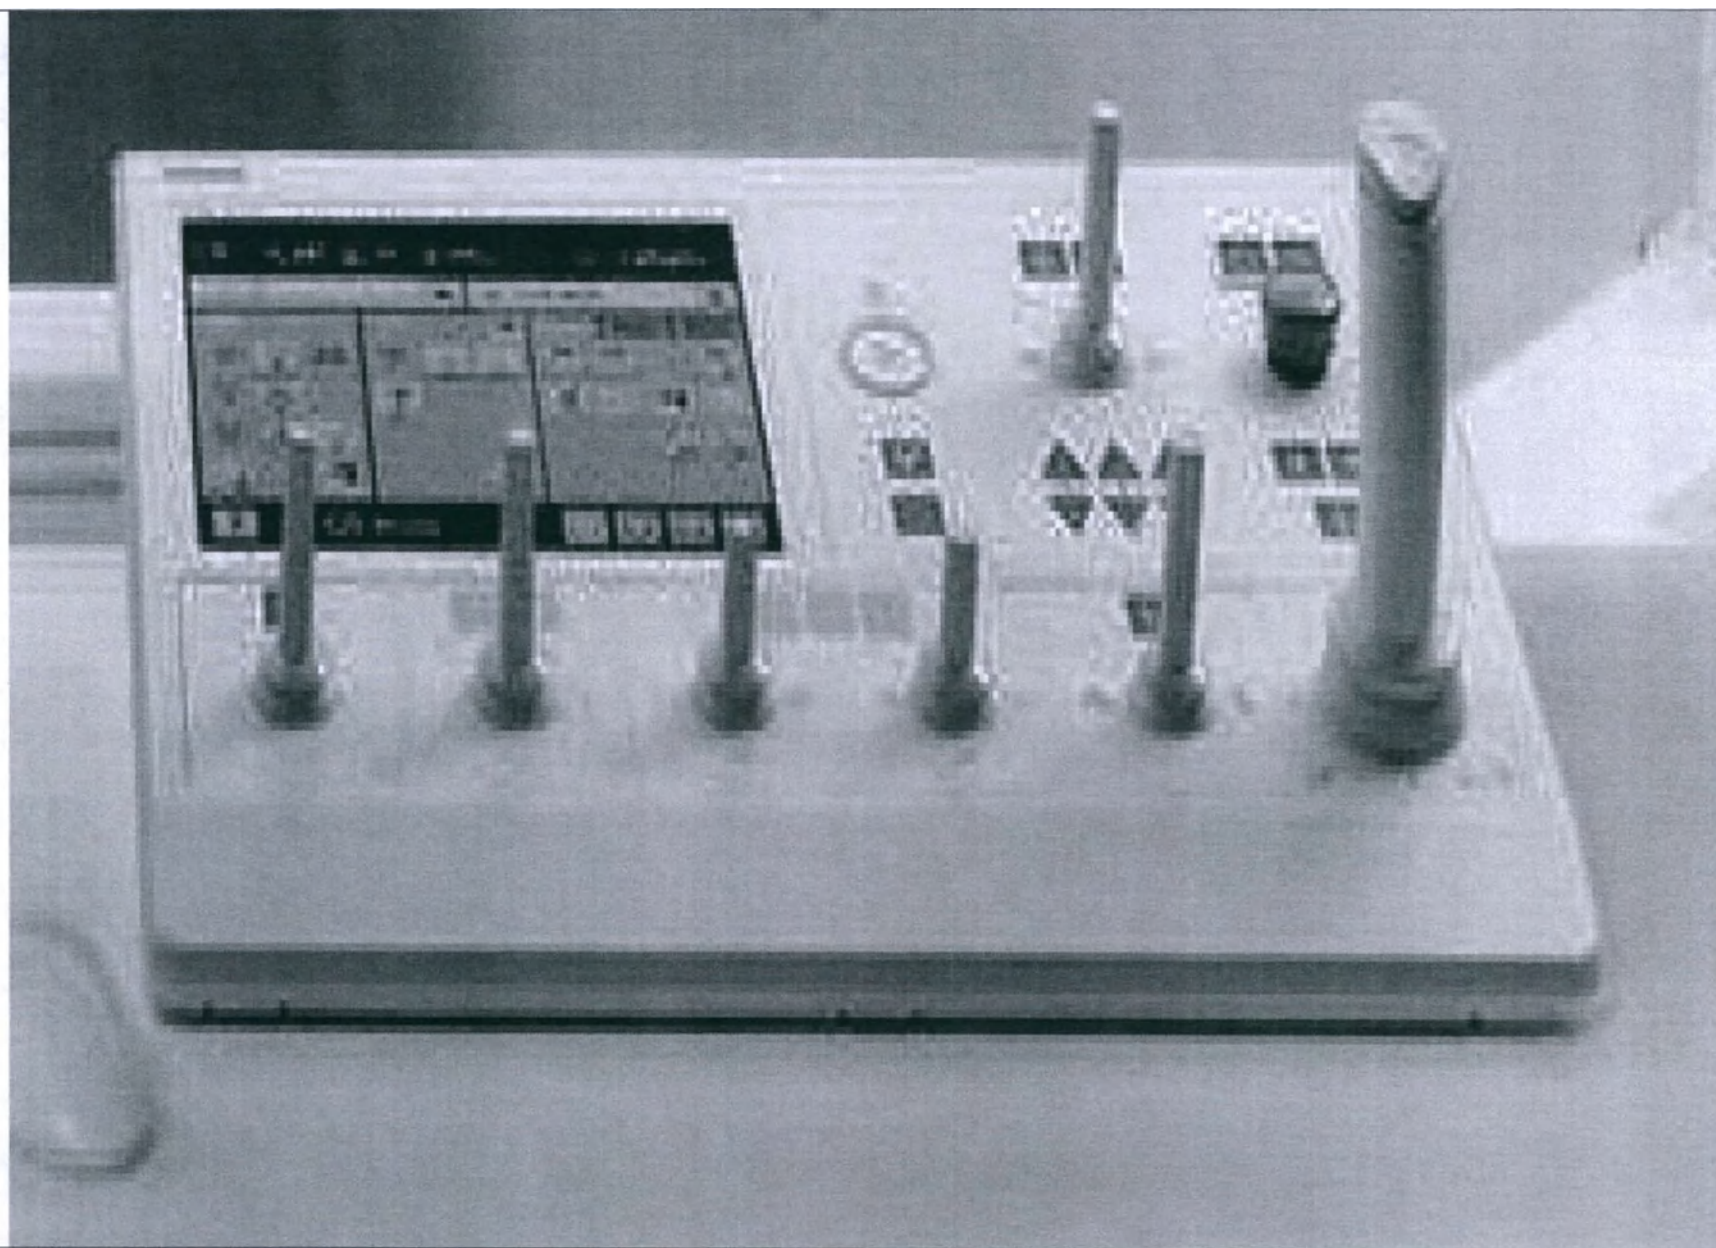


6. Дистанционный пульт управления системой.

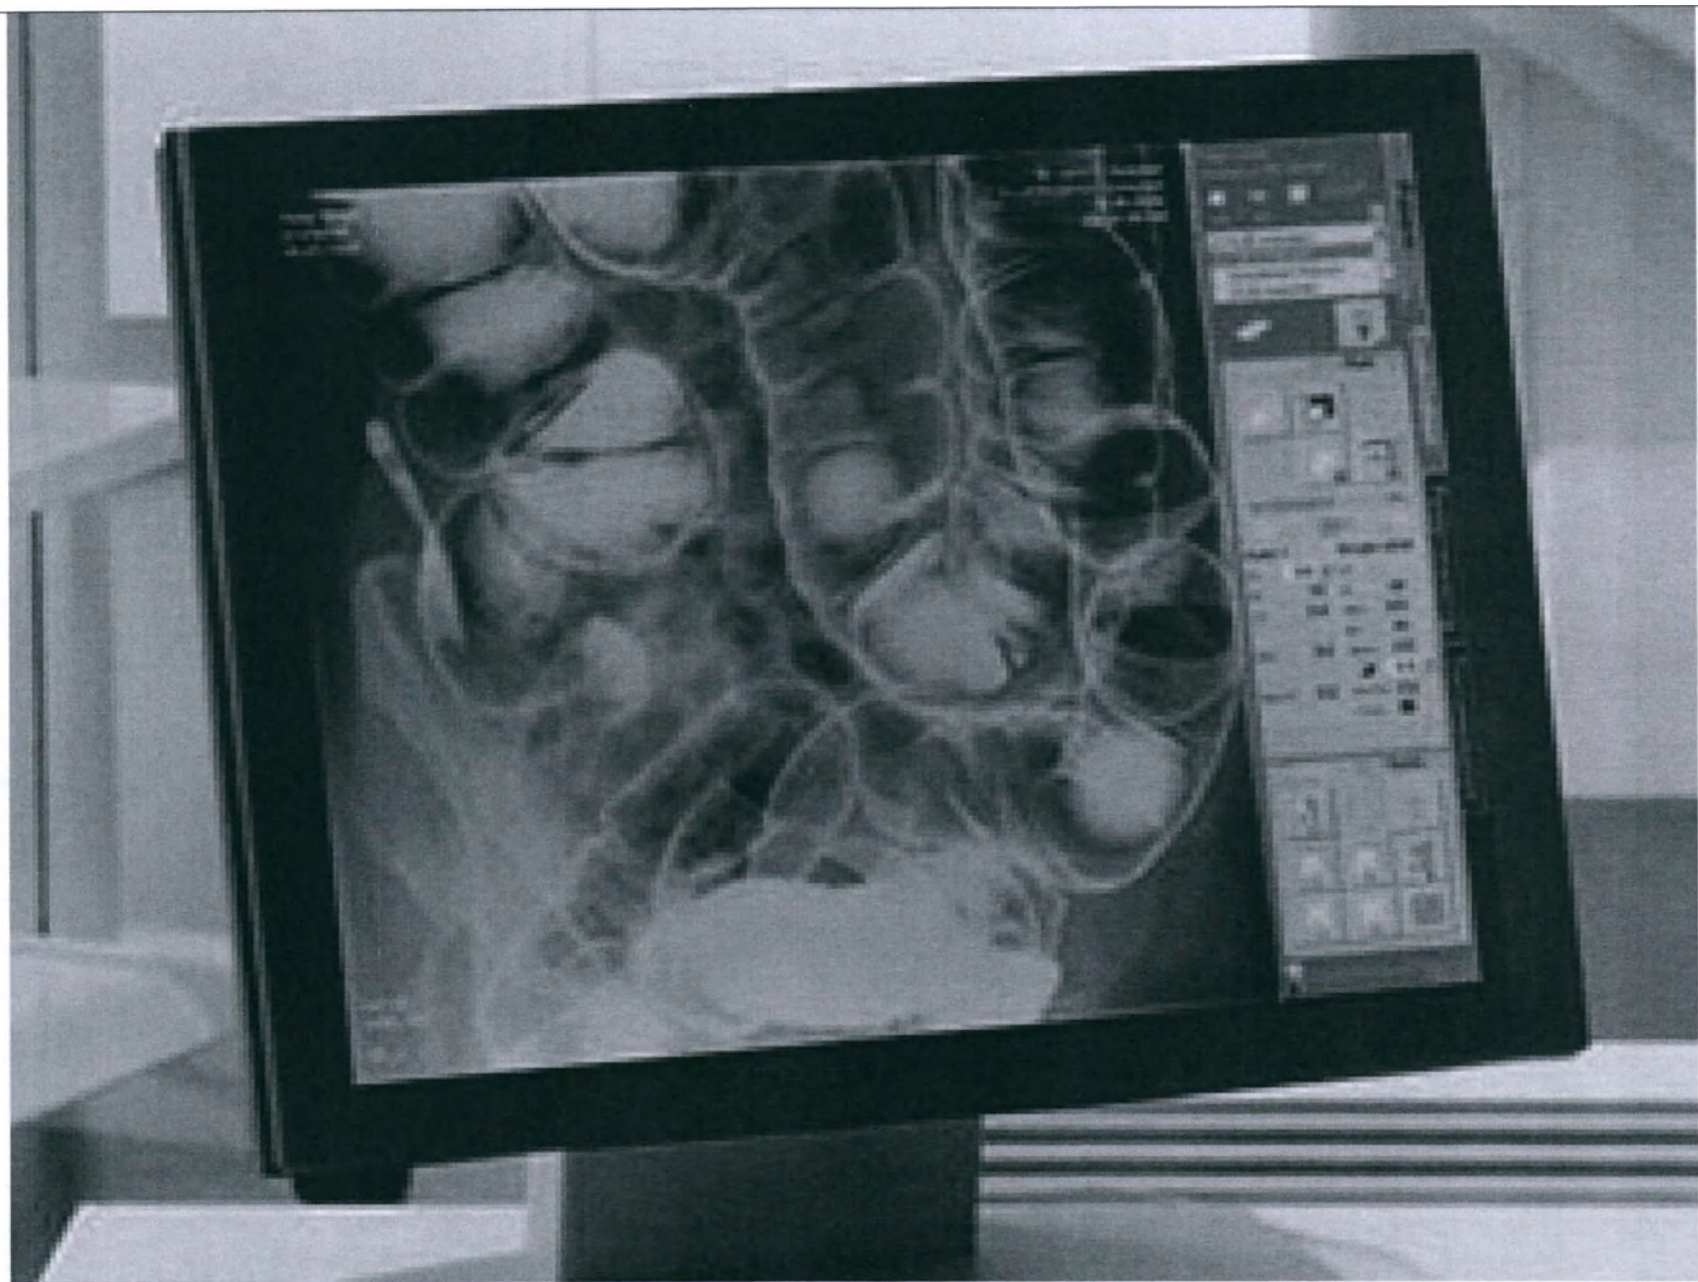

7. Дисплей для пультовой.




8.1 Система формирования изображений FLUOROSPOT Compact с базовым программным обеспечением, мышью и клавиатурой.

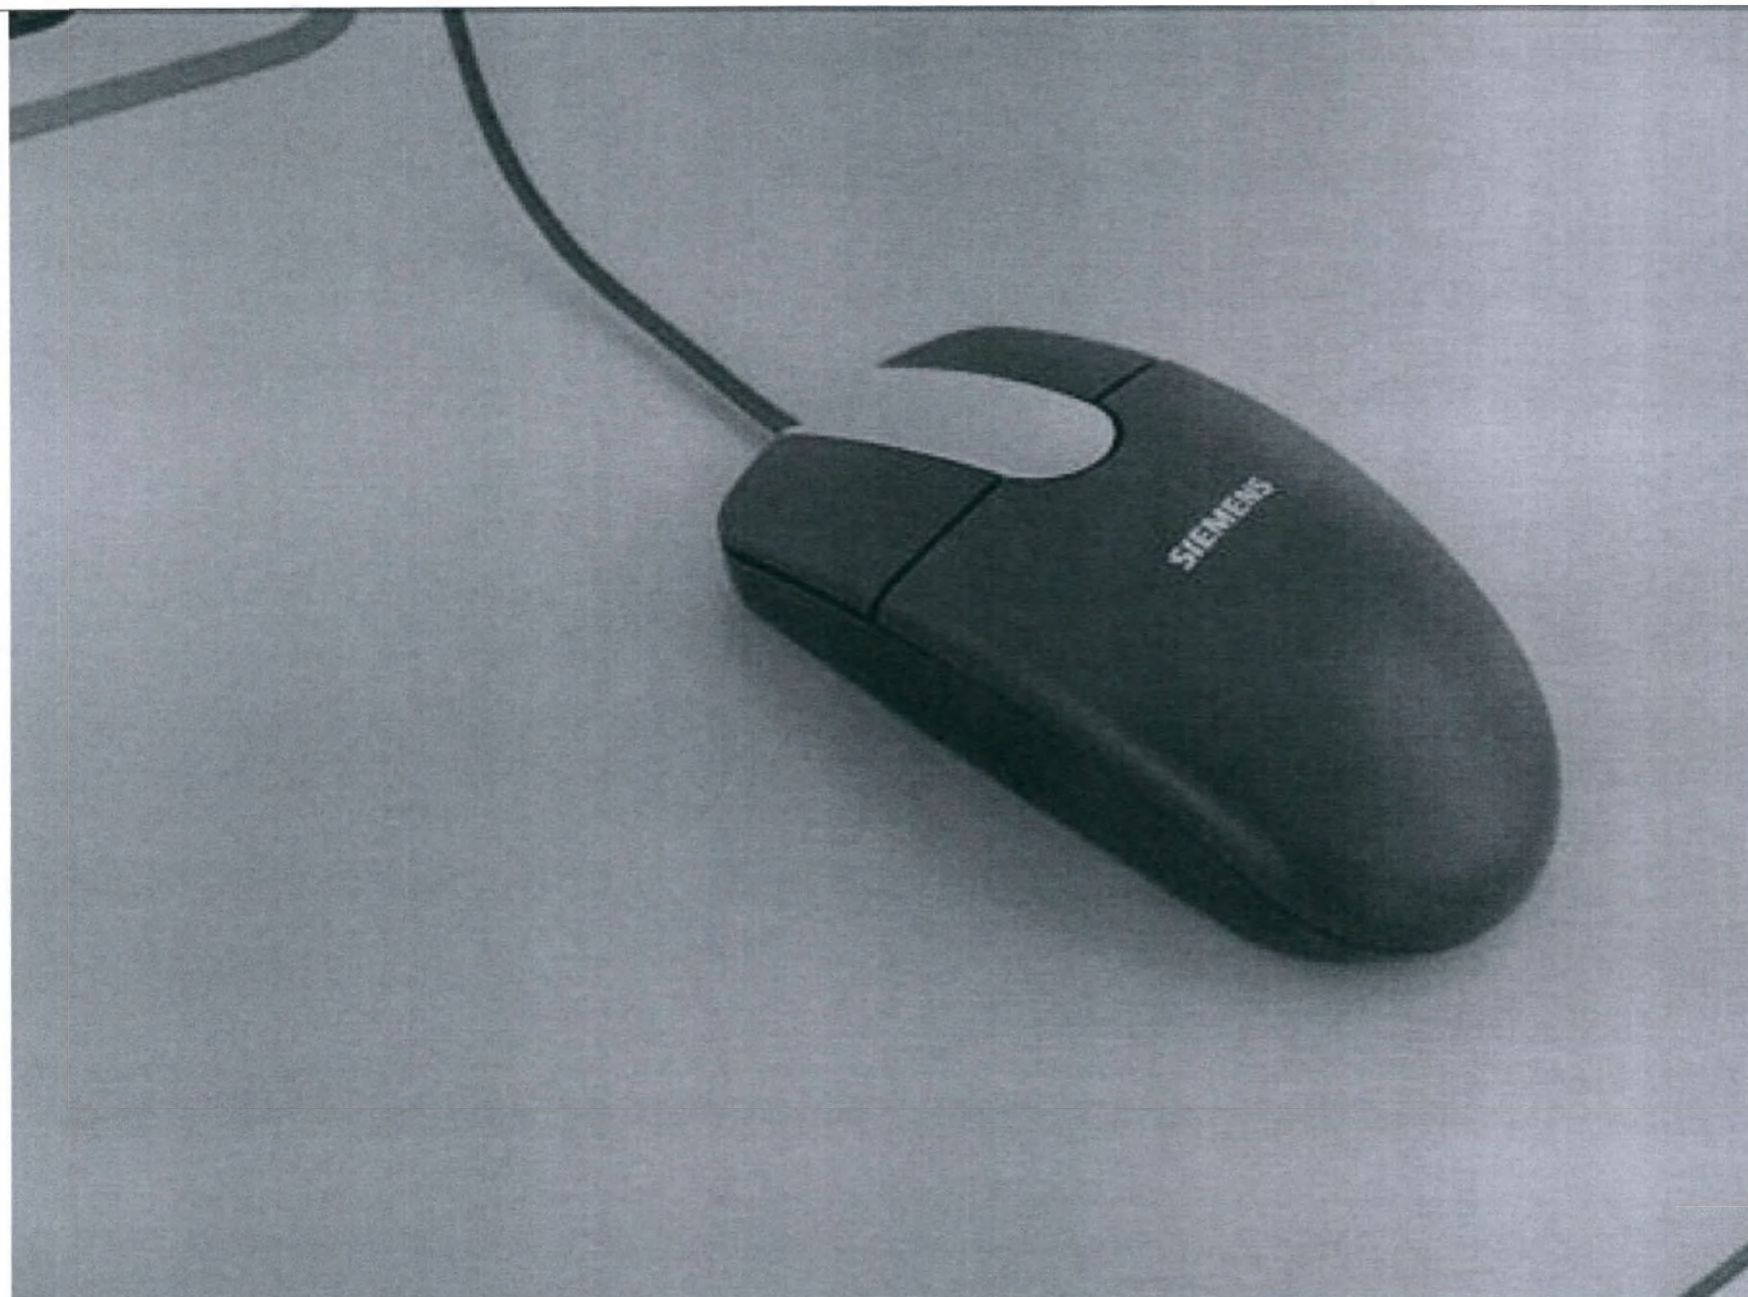


8.2 Система формирования изображений FLUOROSPOT Compact с базовым программным обеспечением, мышью и клавиатурой




8.3 Система формирования изображений FLUOROSPOT Compact с базовым программным обеспечением, мышью и клавиатурой.

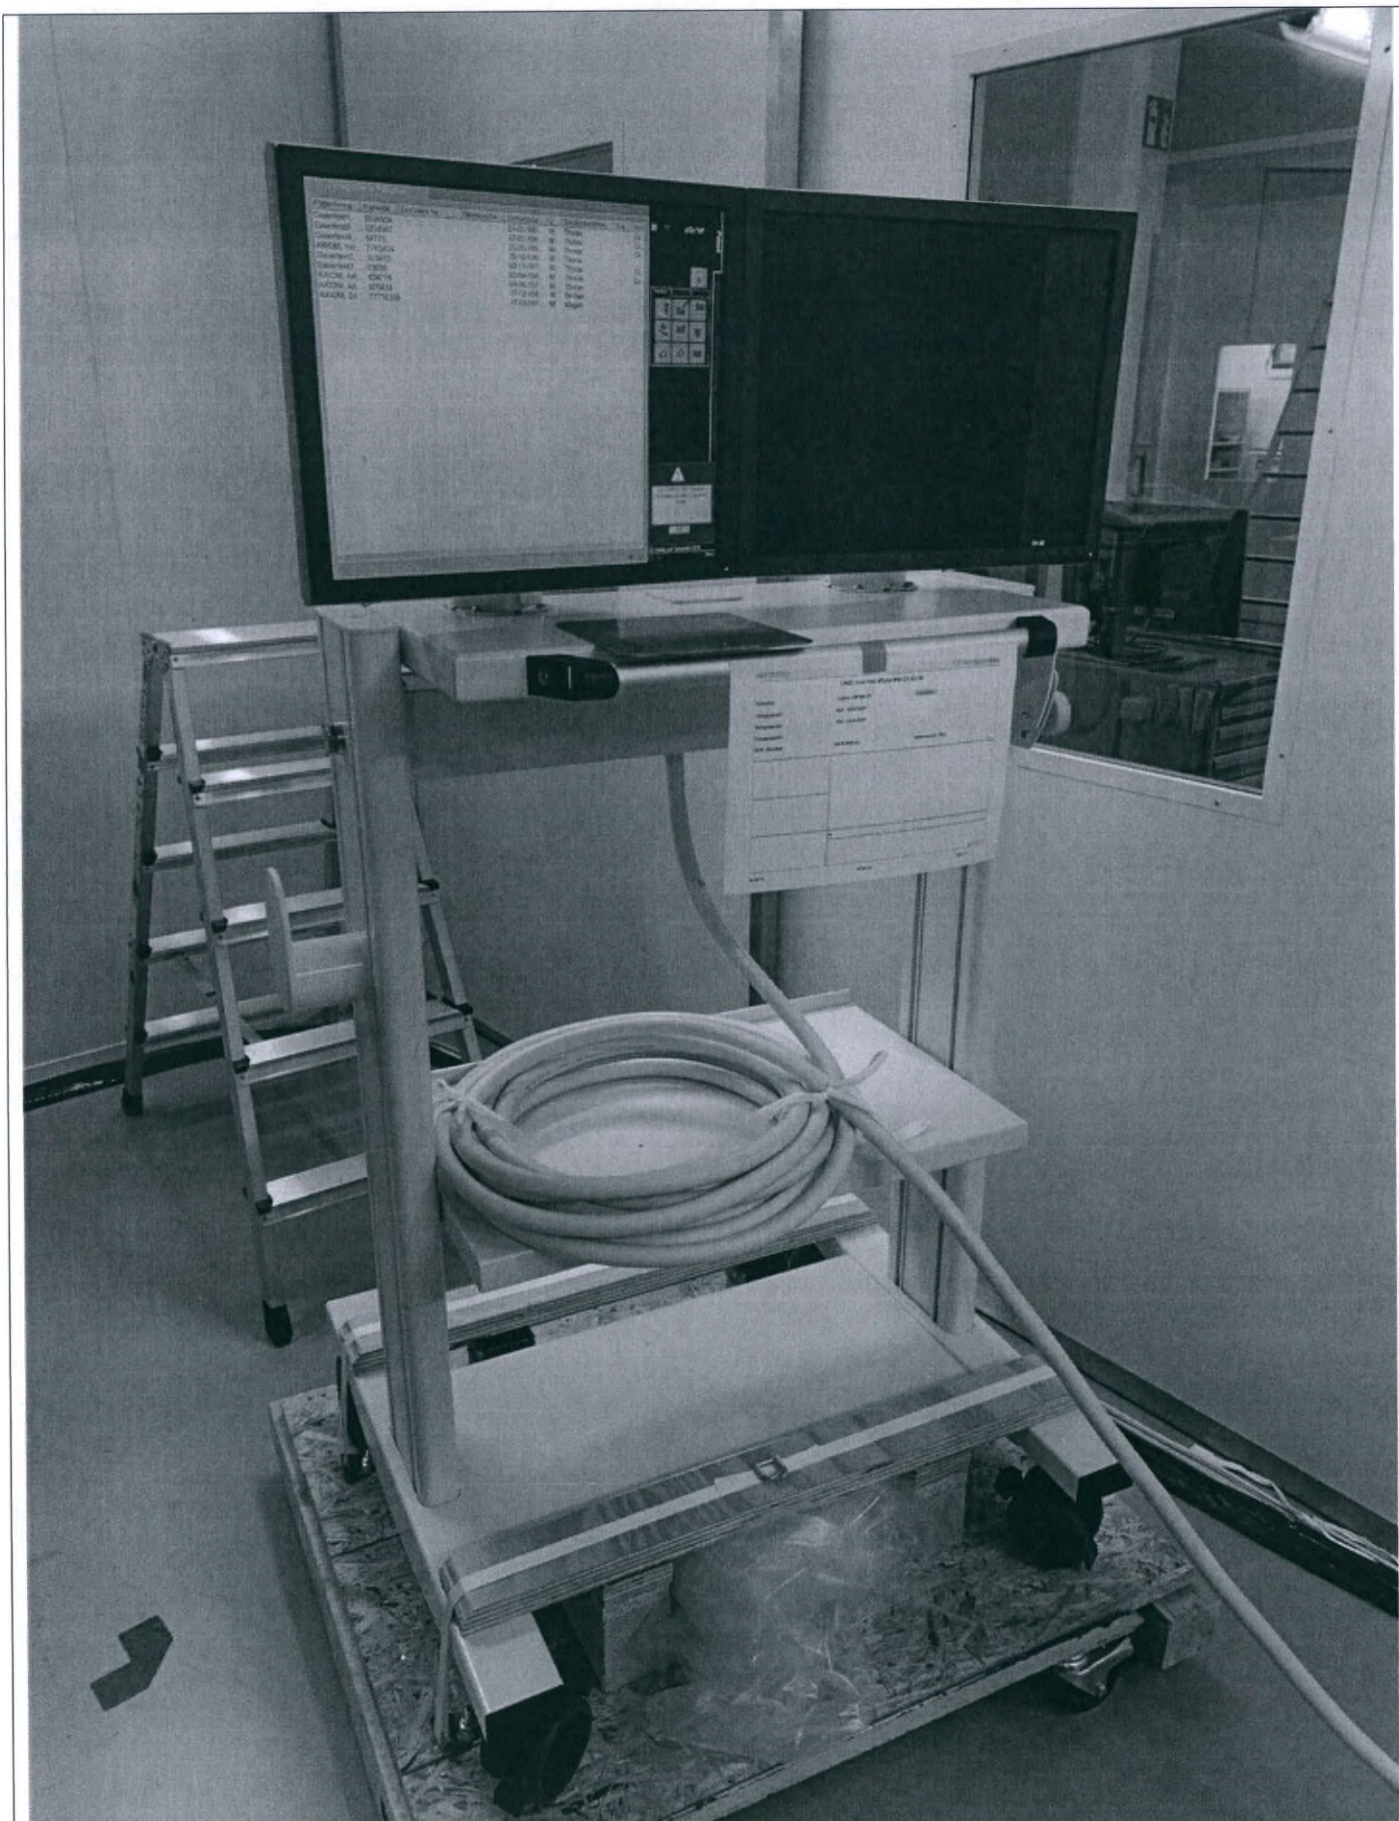

9.1 Тележка с одним или двумя дисплеями

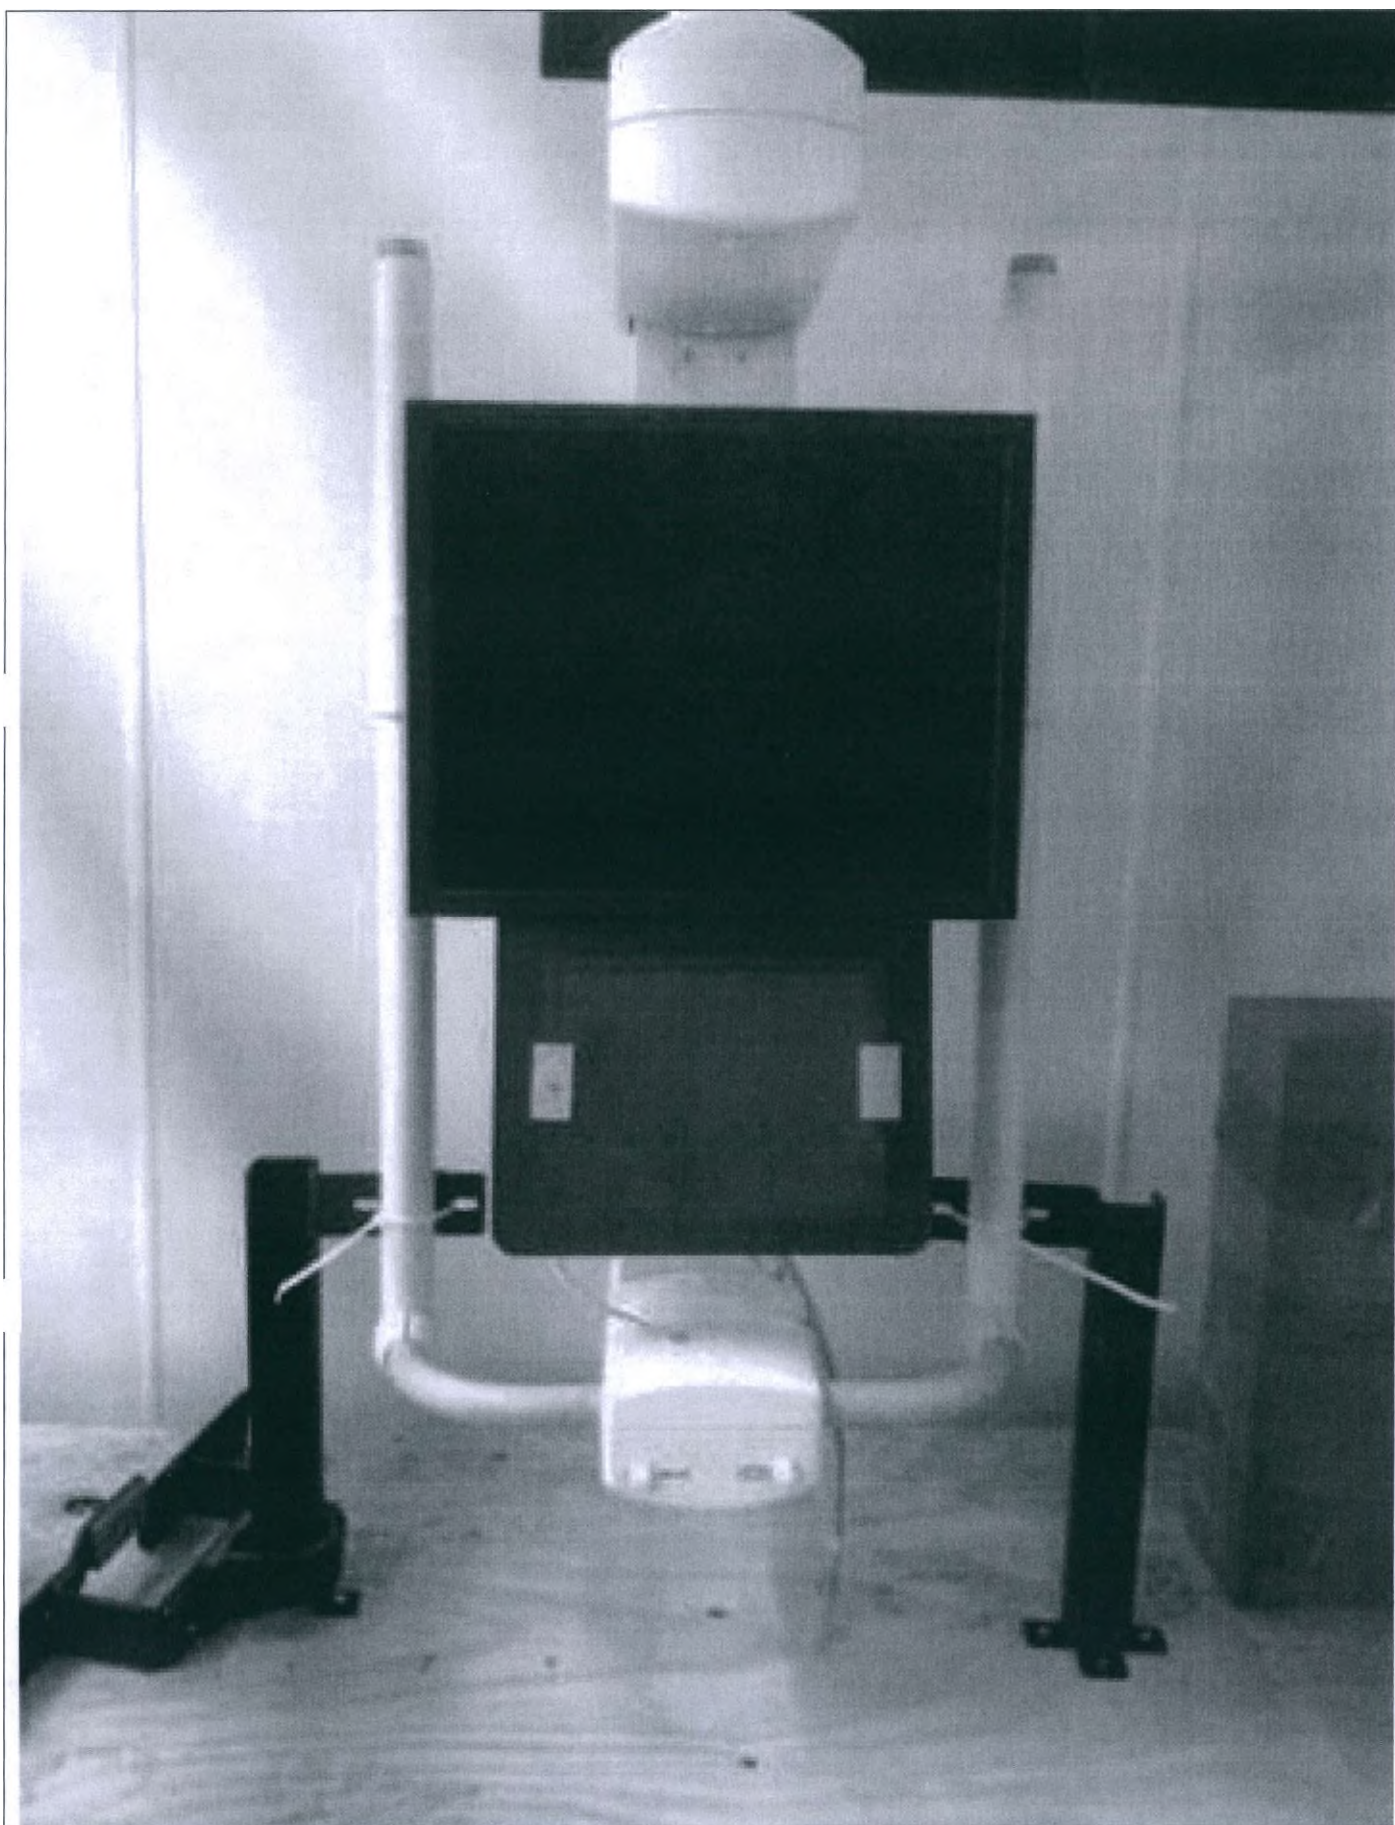


9.2 Потолочная подвеска с одним или двумя дисплеями

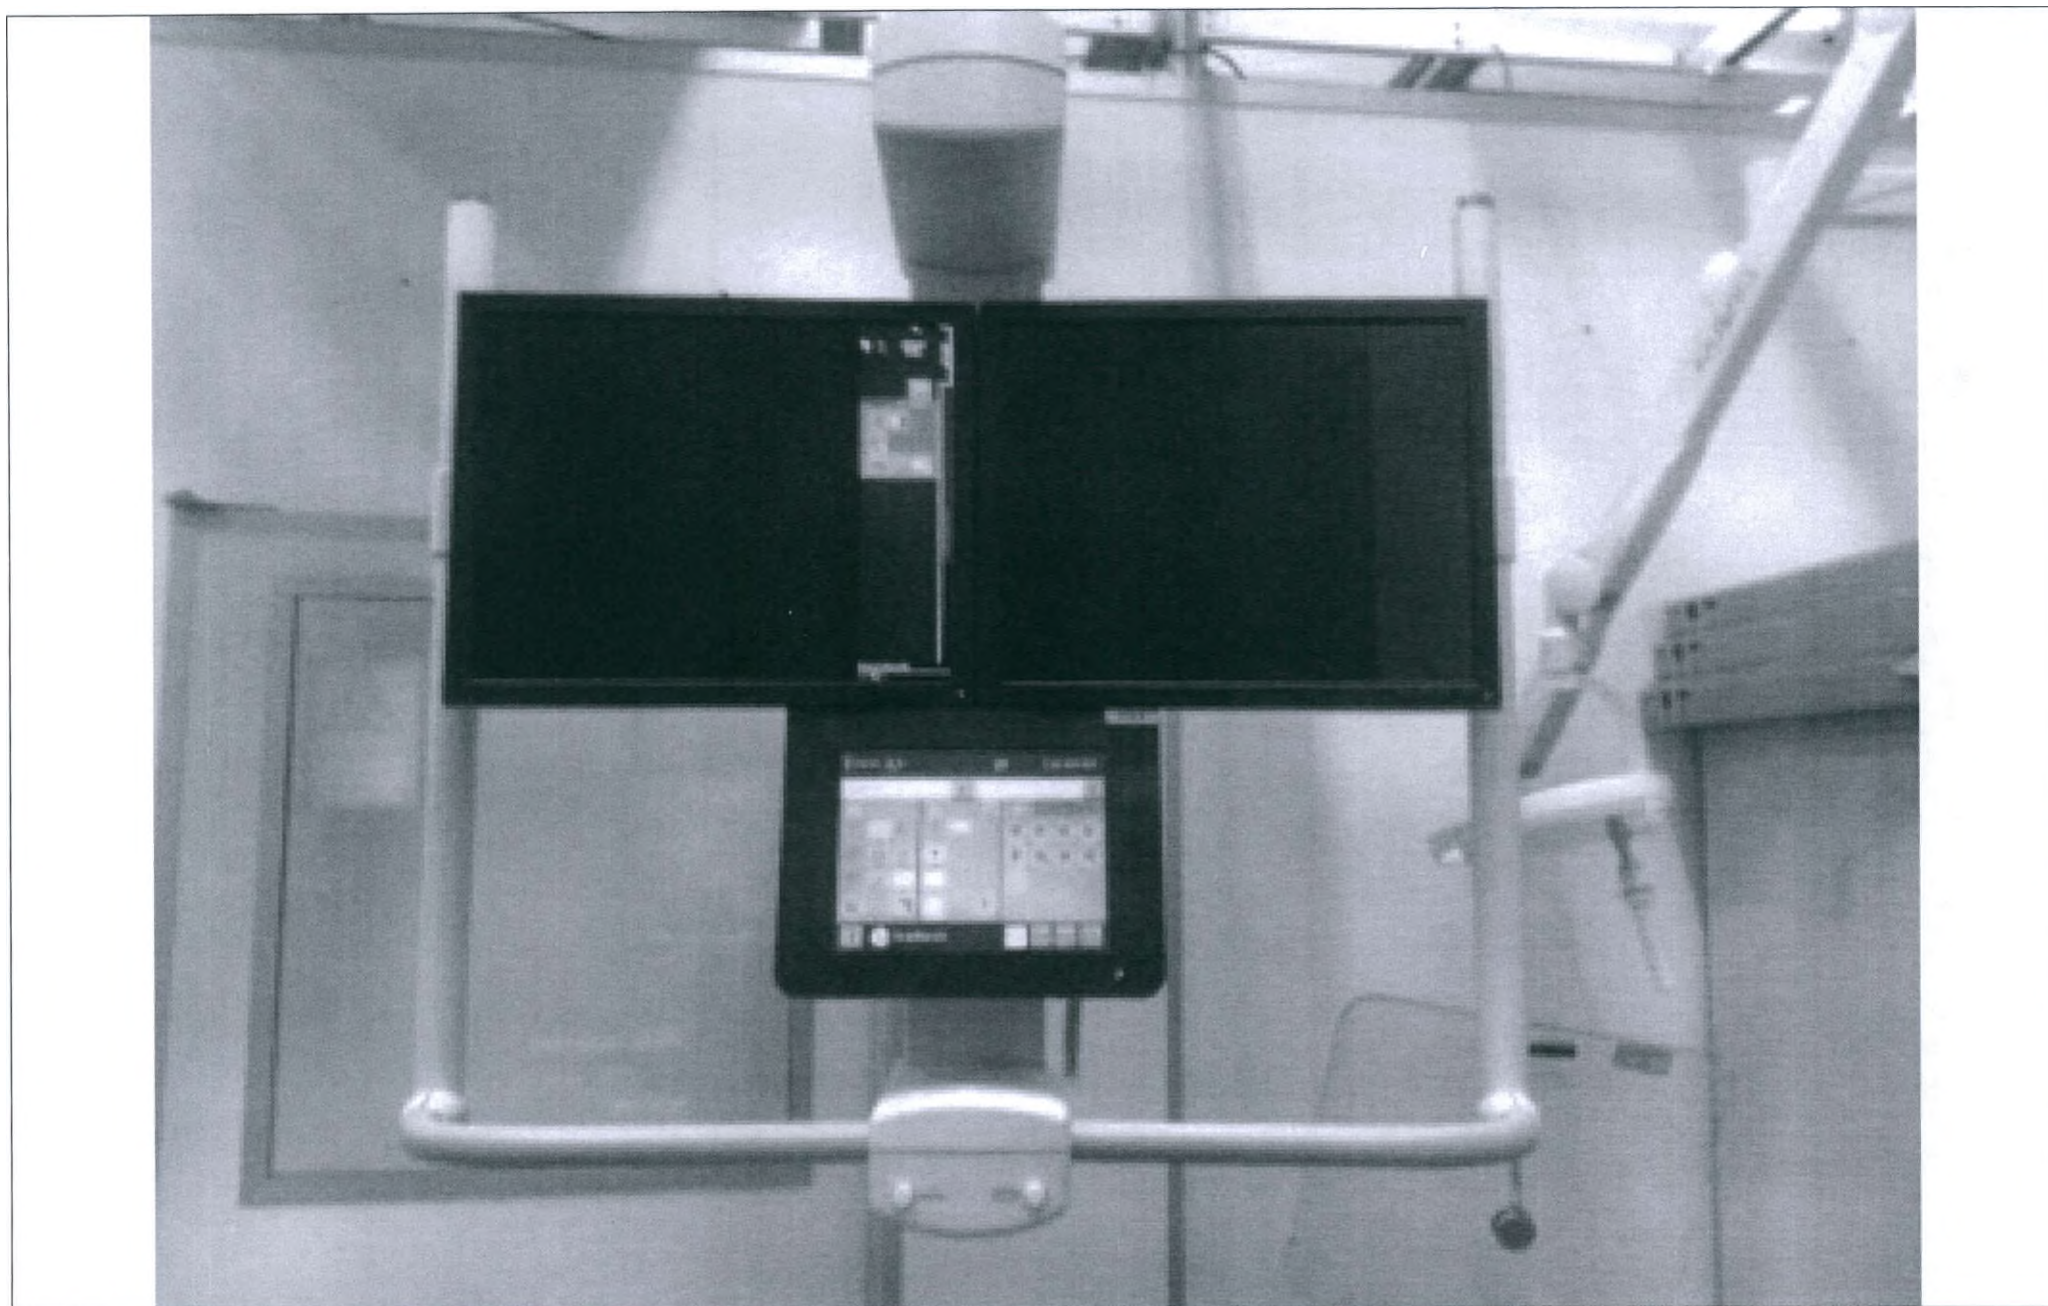


9.3 Потолочная подвеска с одним или двумя дисплеями.




10. Педальный переключатель для рентгеноскопии и рентгенографии.

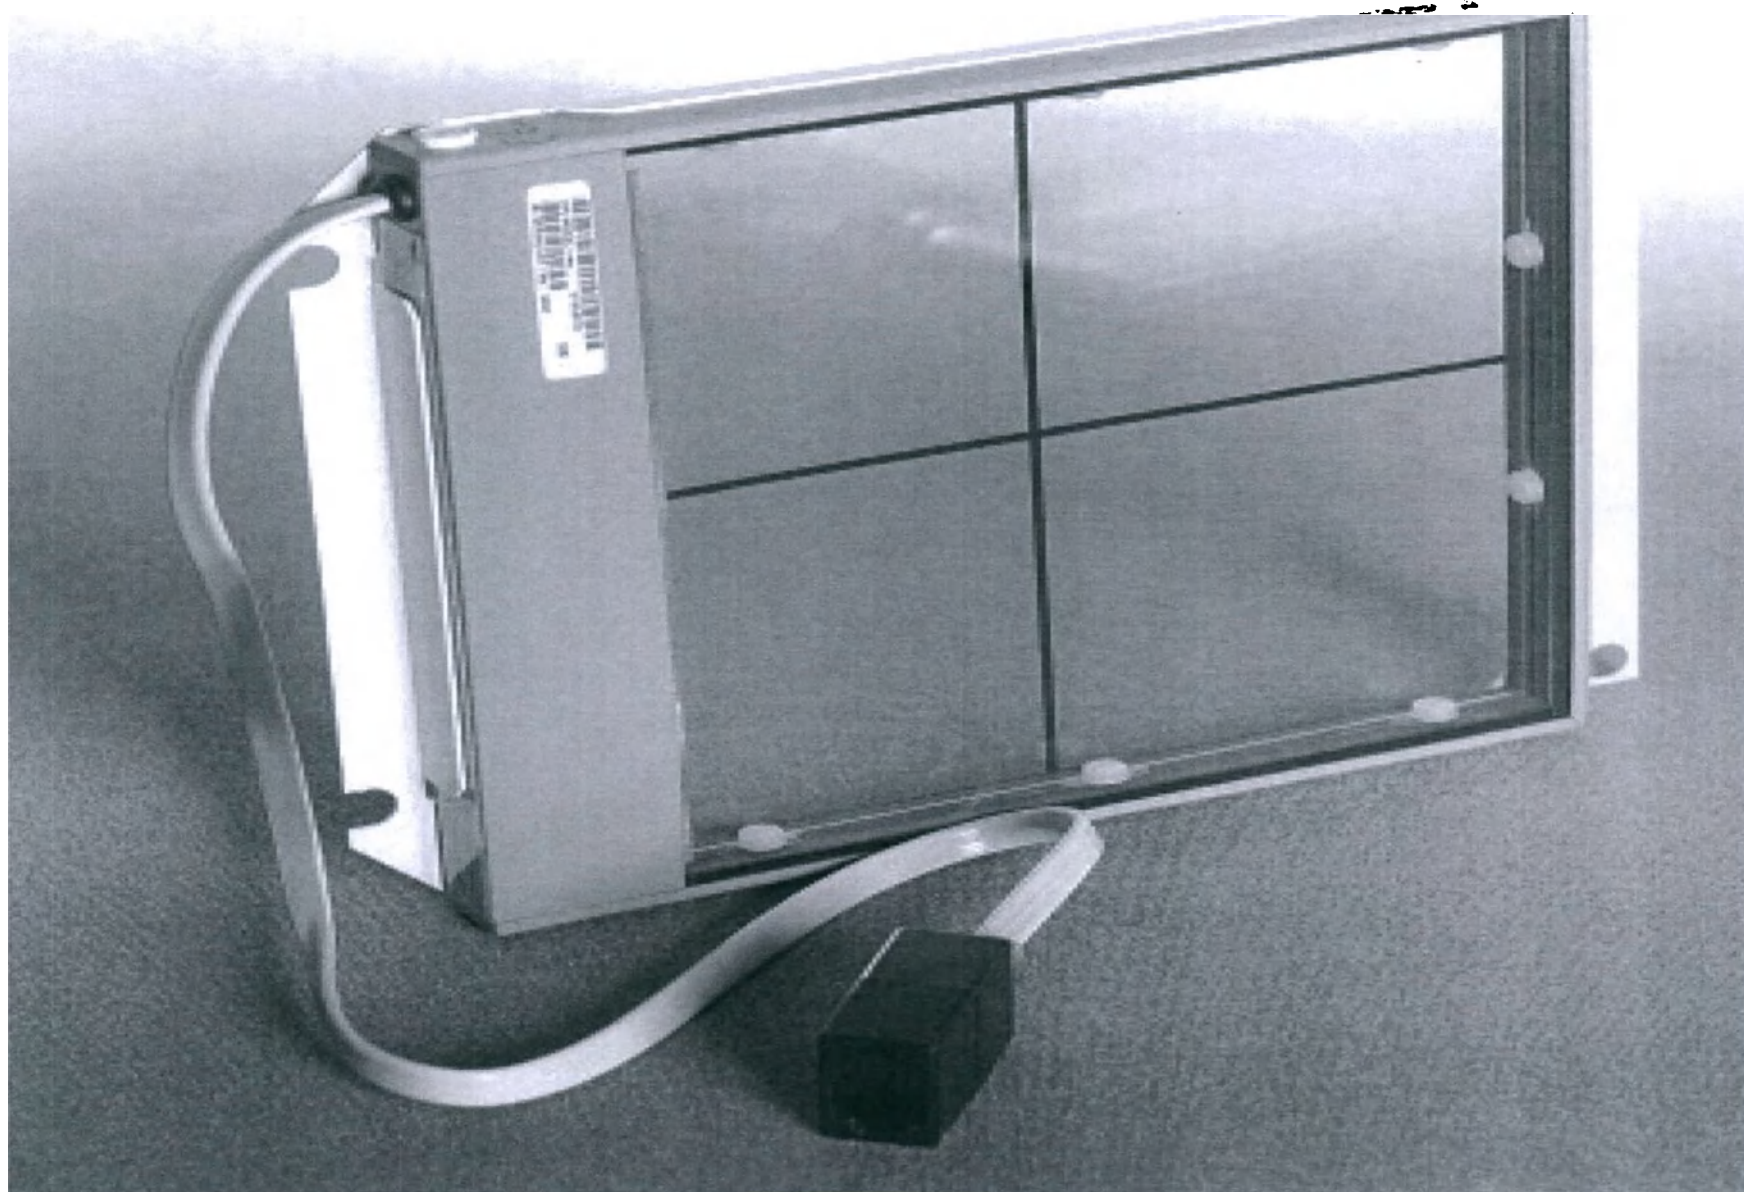


11. Устройство измерения суммарной поверхностной дозы.

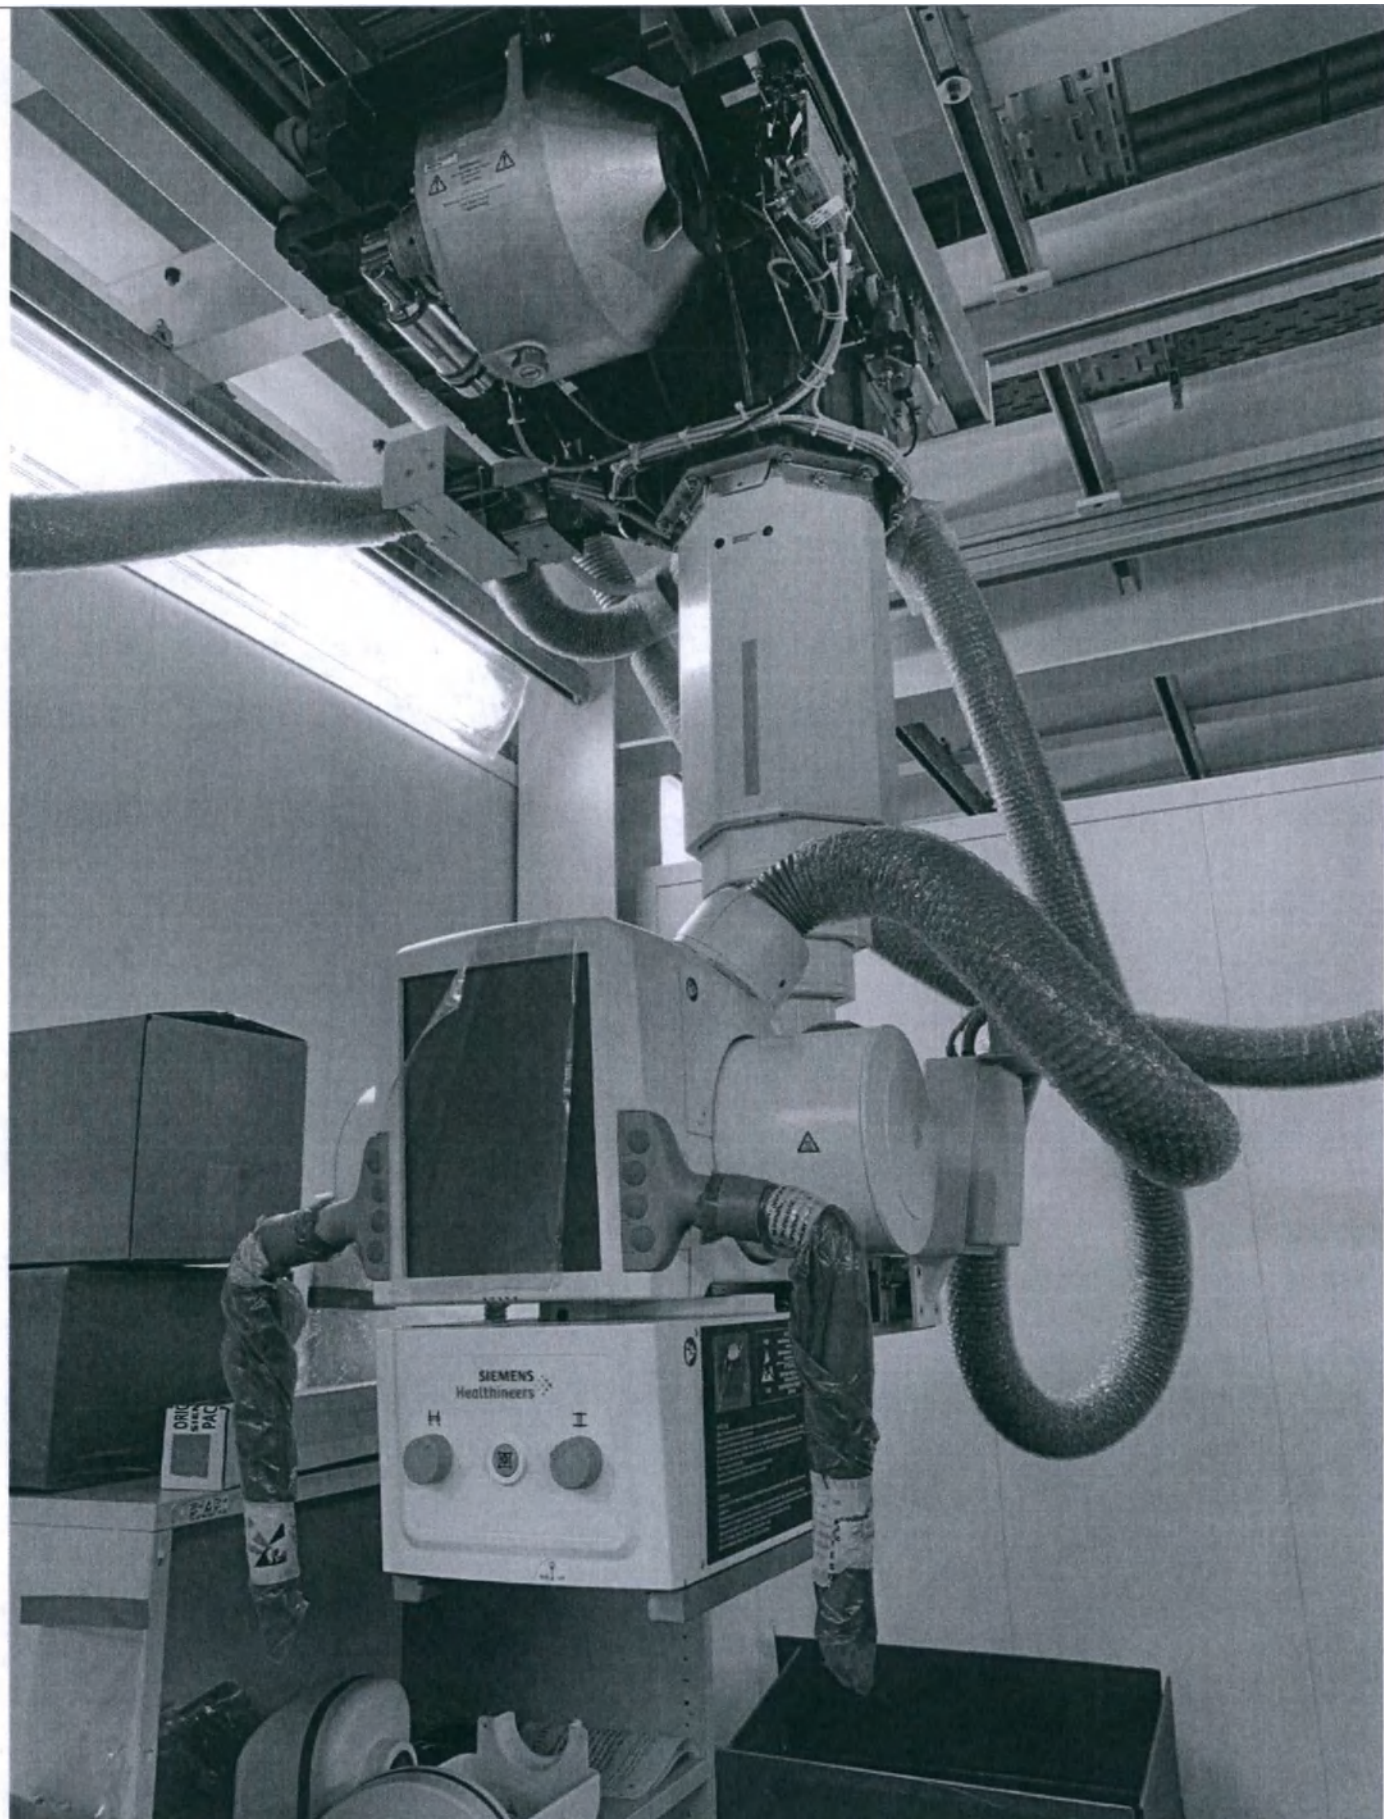


12. Потолочный 3D-штатив с рентгеновской трубкой.

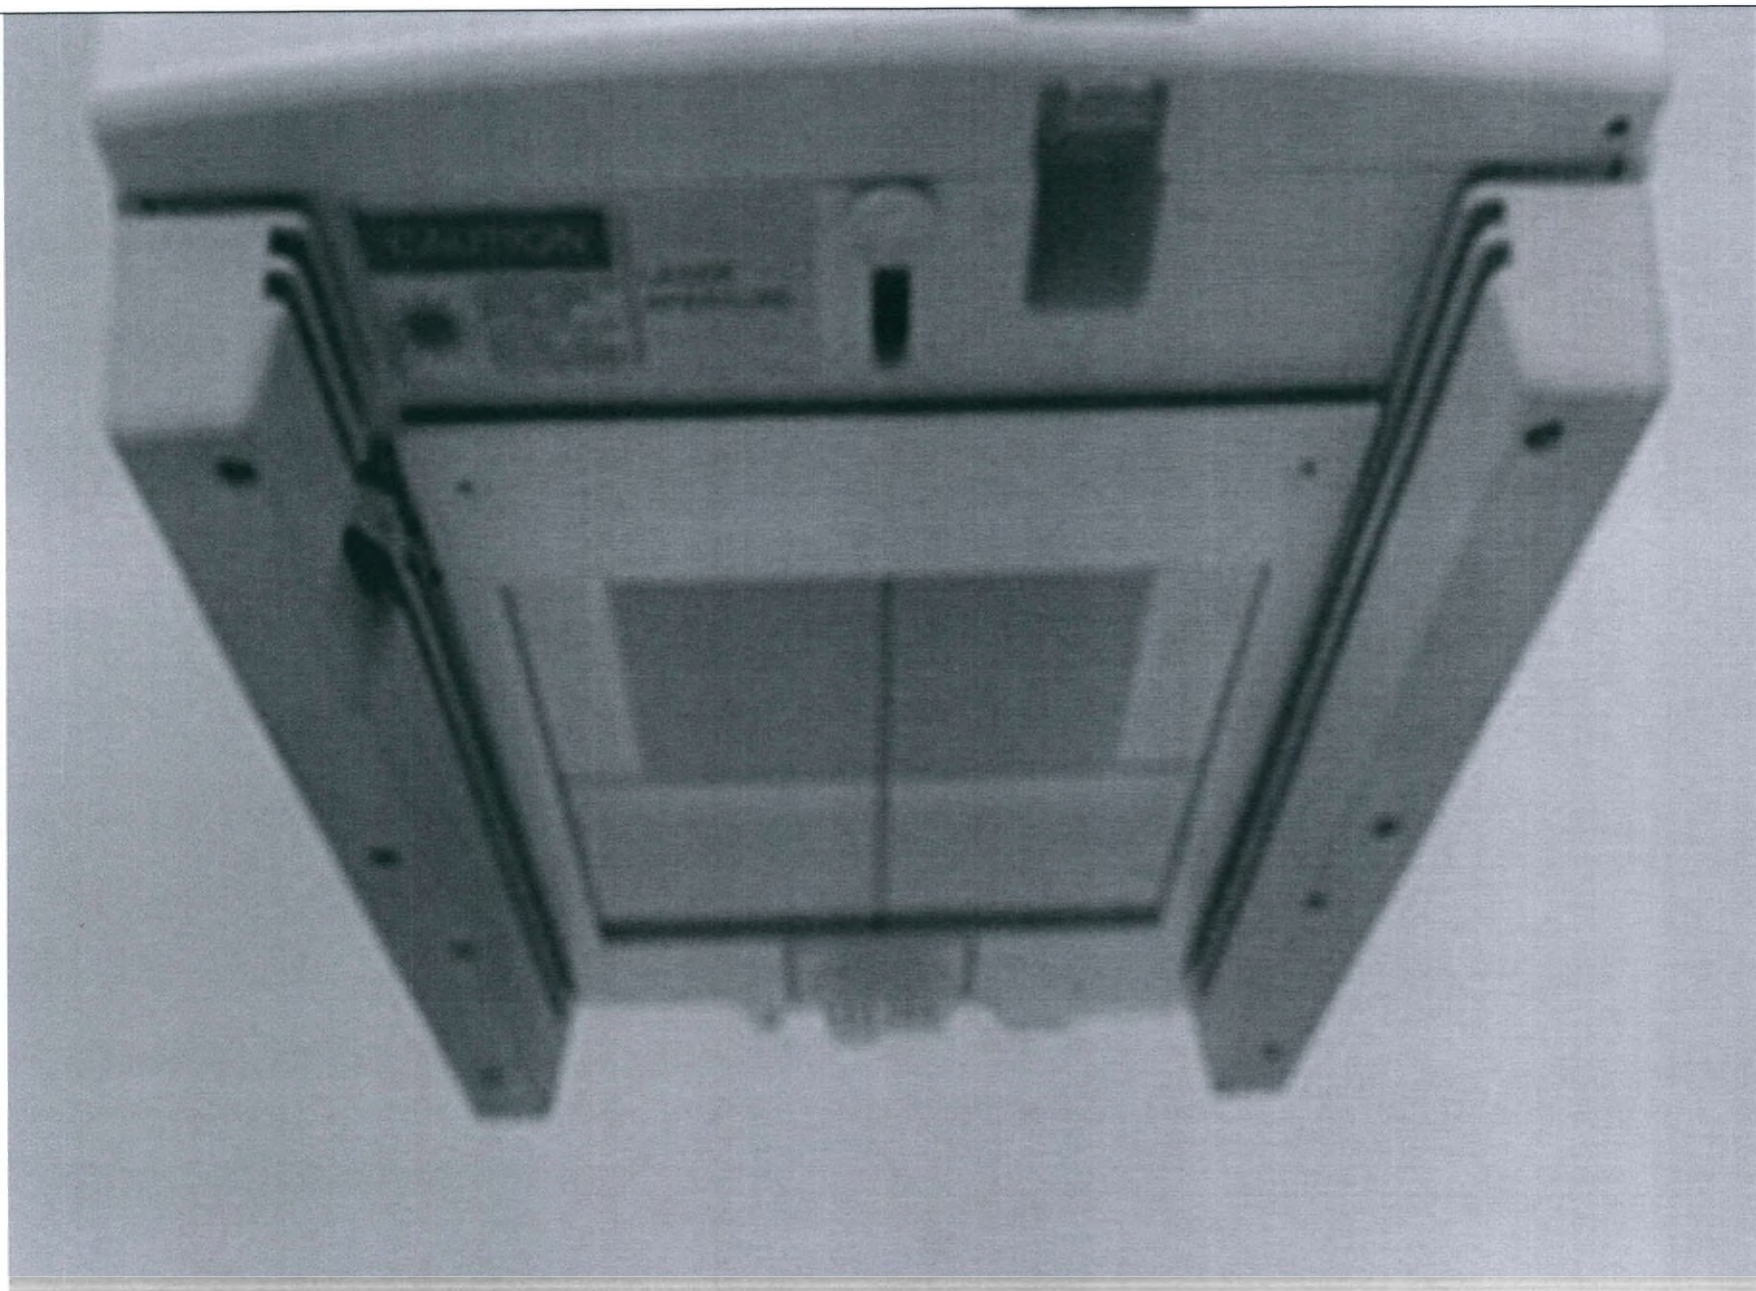

13. Устройство измерения суммарной поверхностной доз для трубки с потолочным креплением.

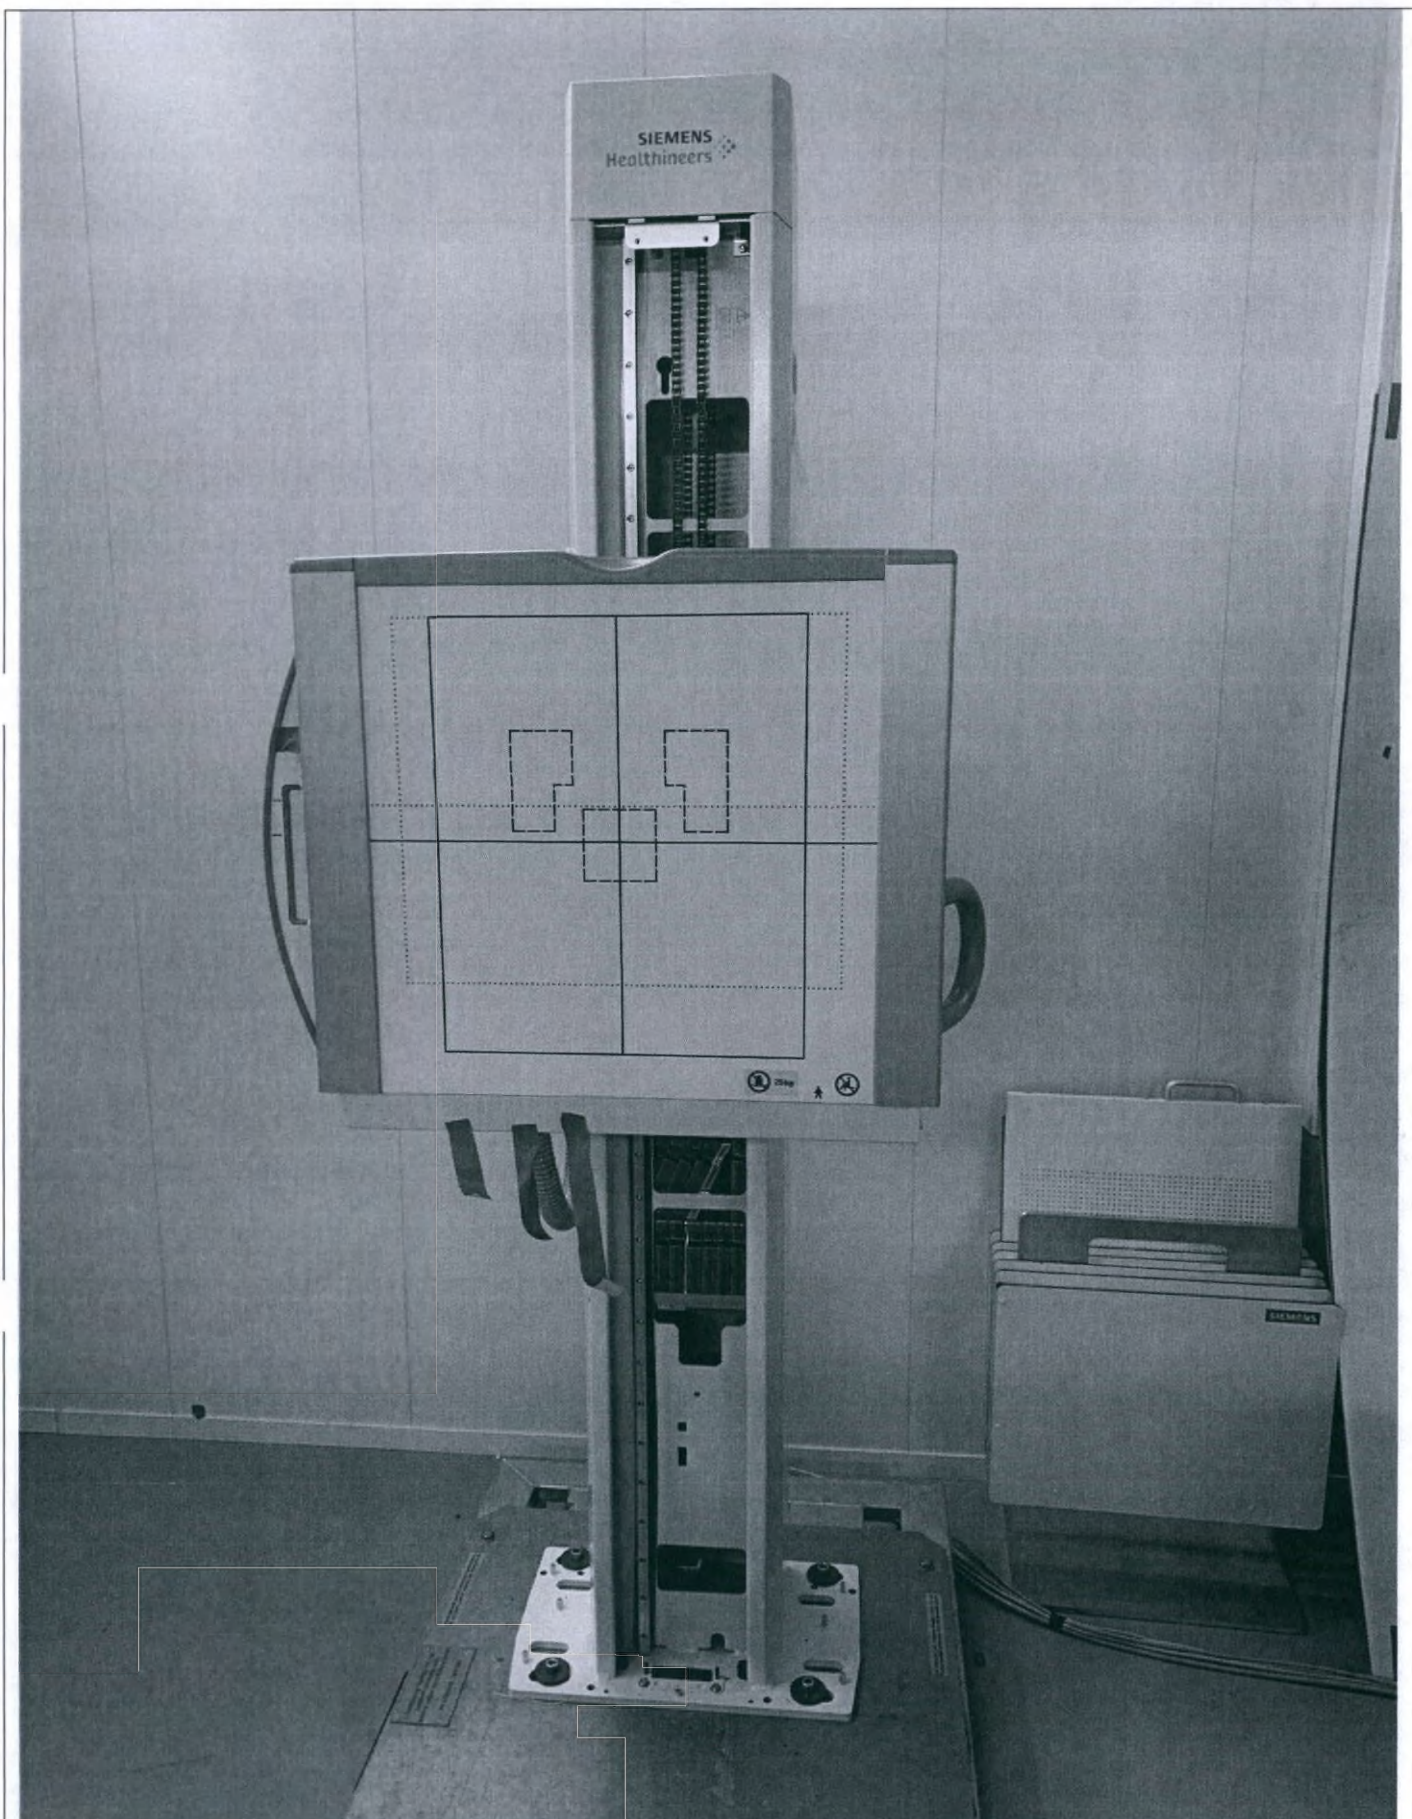

14. Вертикальная стойка, варианты исполнения:
- с плоским стационарным детектором;
- для беспроводного детектора.

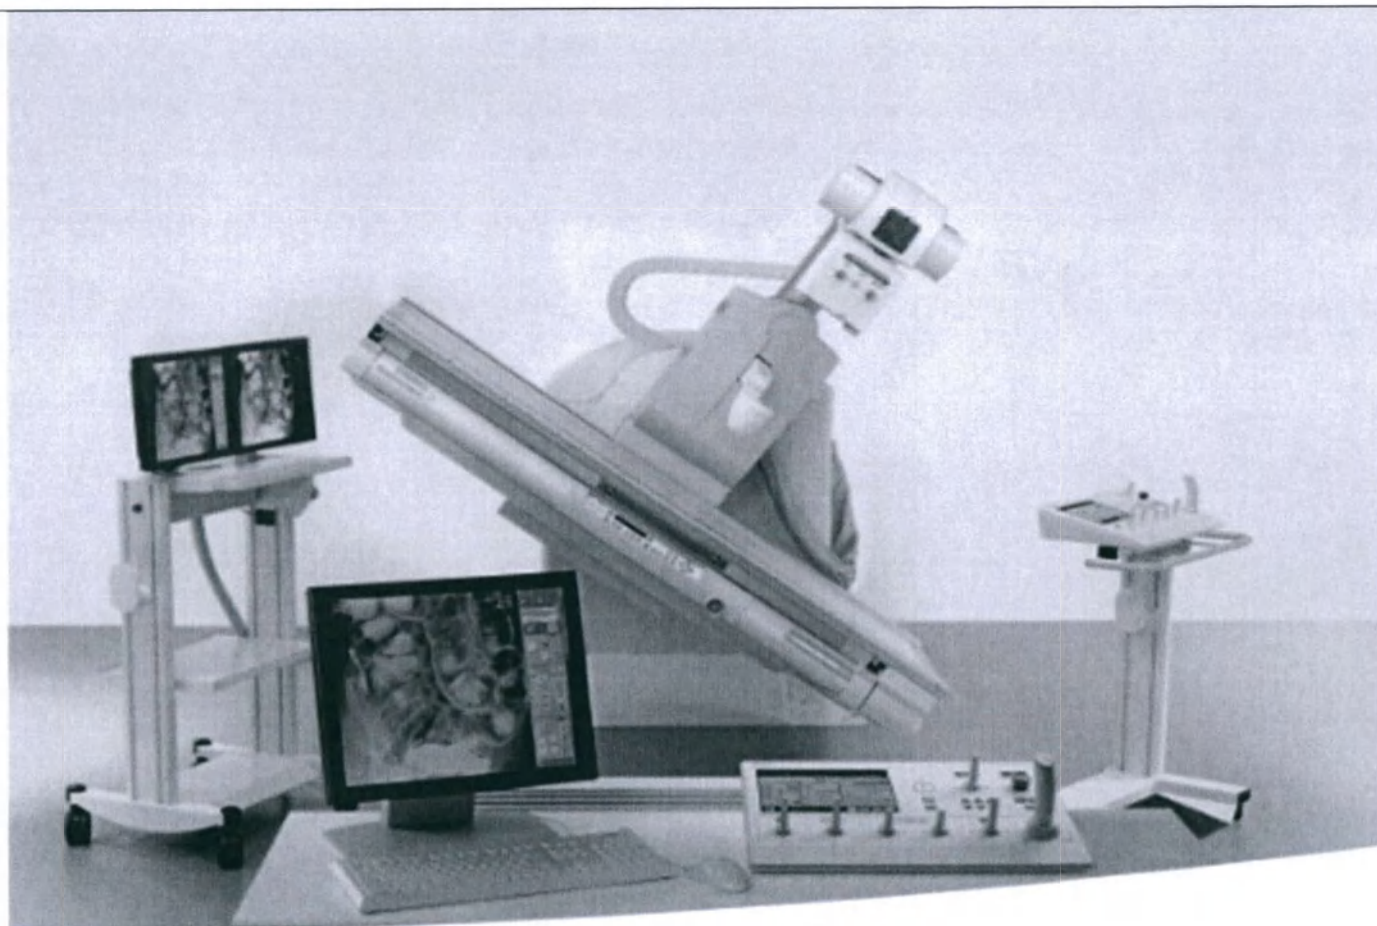


Luminos dRF Max

Руководство пользователя – VF11 и более поздние версии

siemens-healthineers.com


SIEMENS
Healthineers

15. Документация пользователя на русском языке.

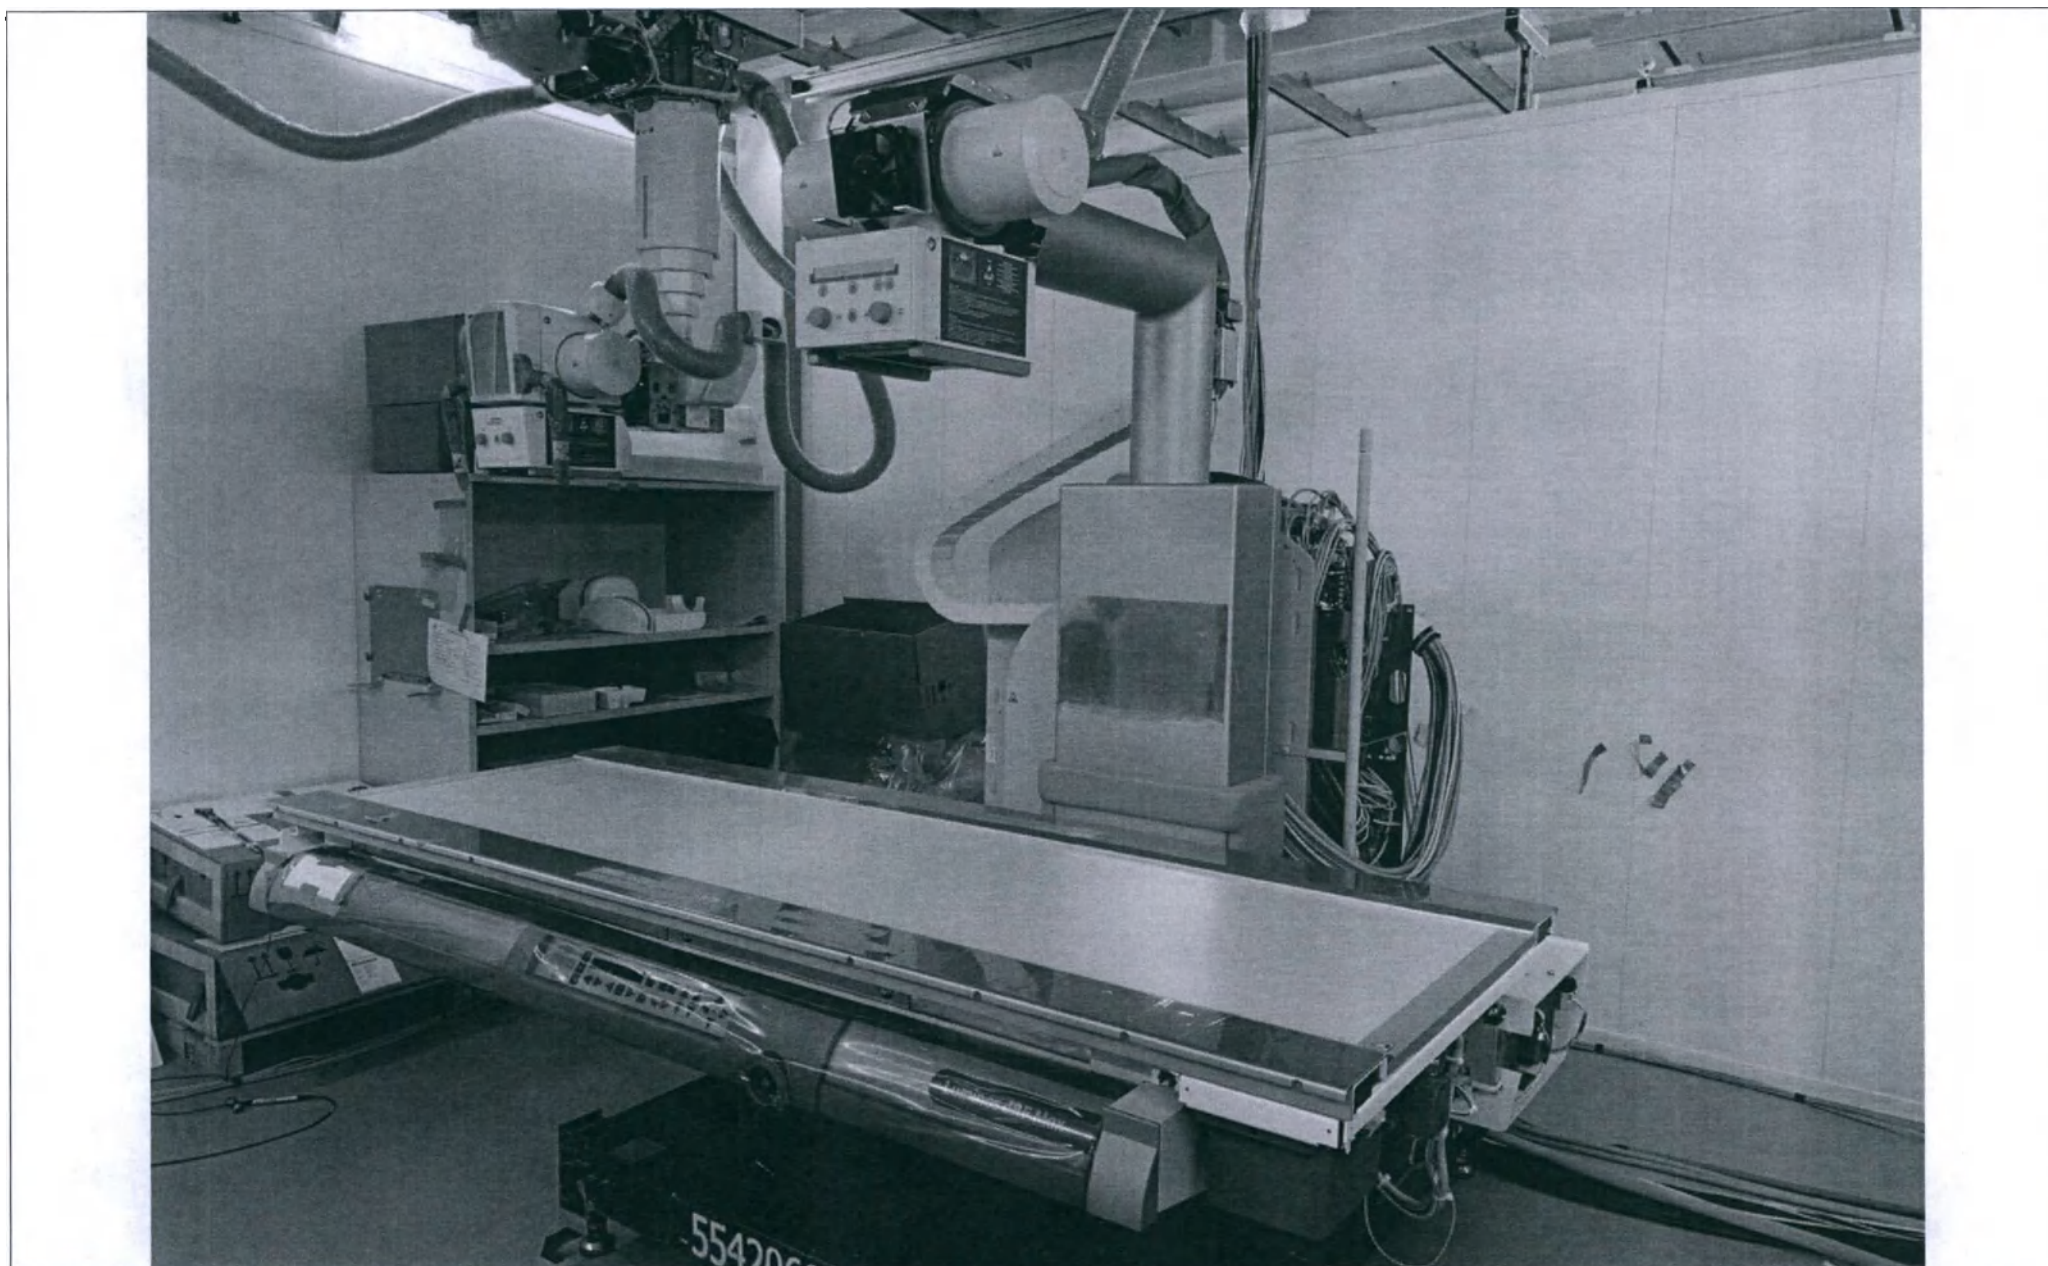


1. Телеуправляемый стол-штатив Luminos dRF Max


4. Базовый блок, вариант 4.

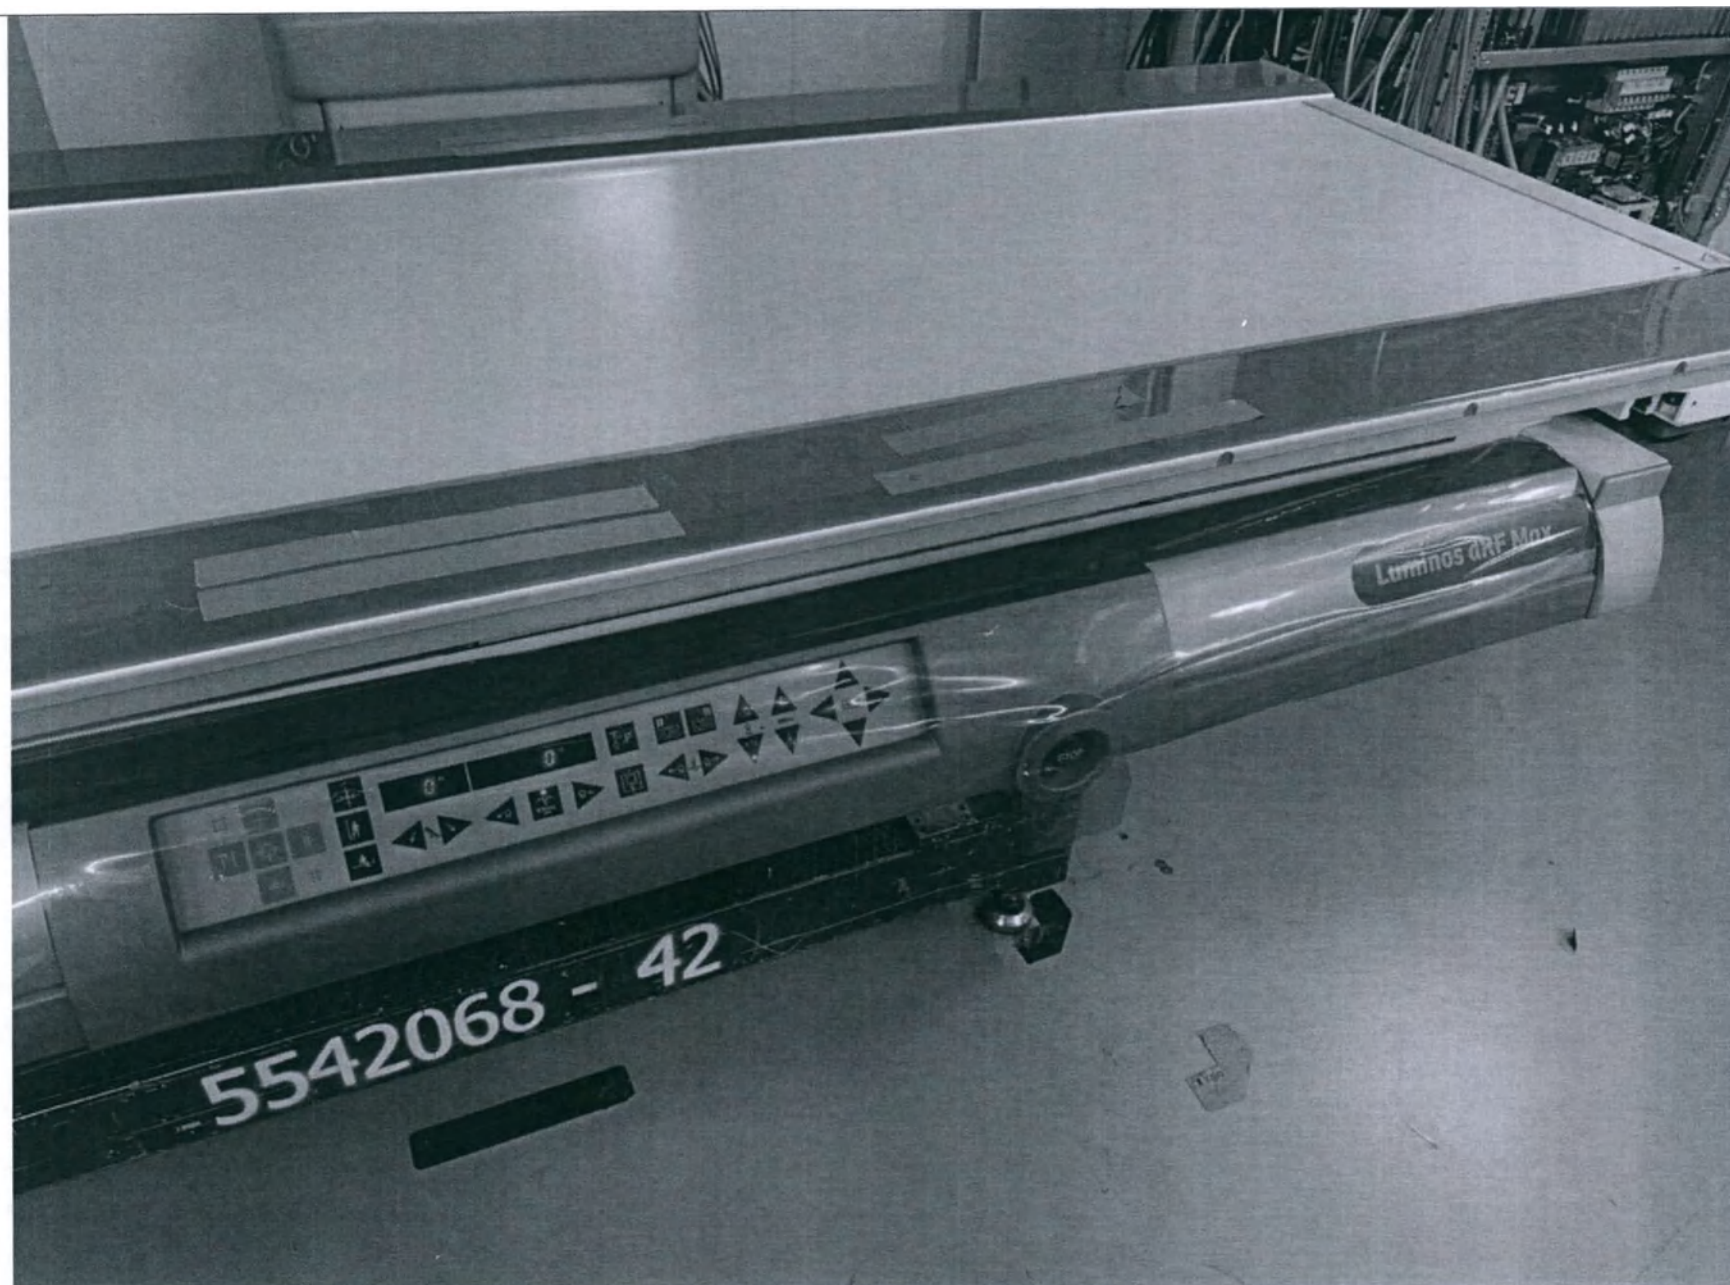


2.1 Плоский детектор.

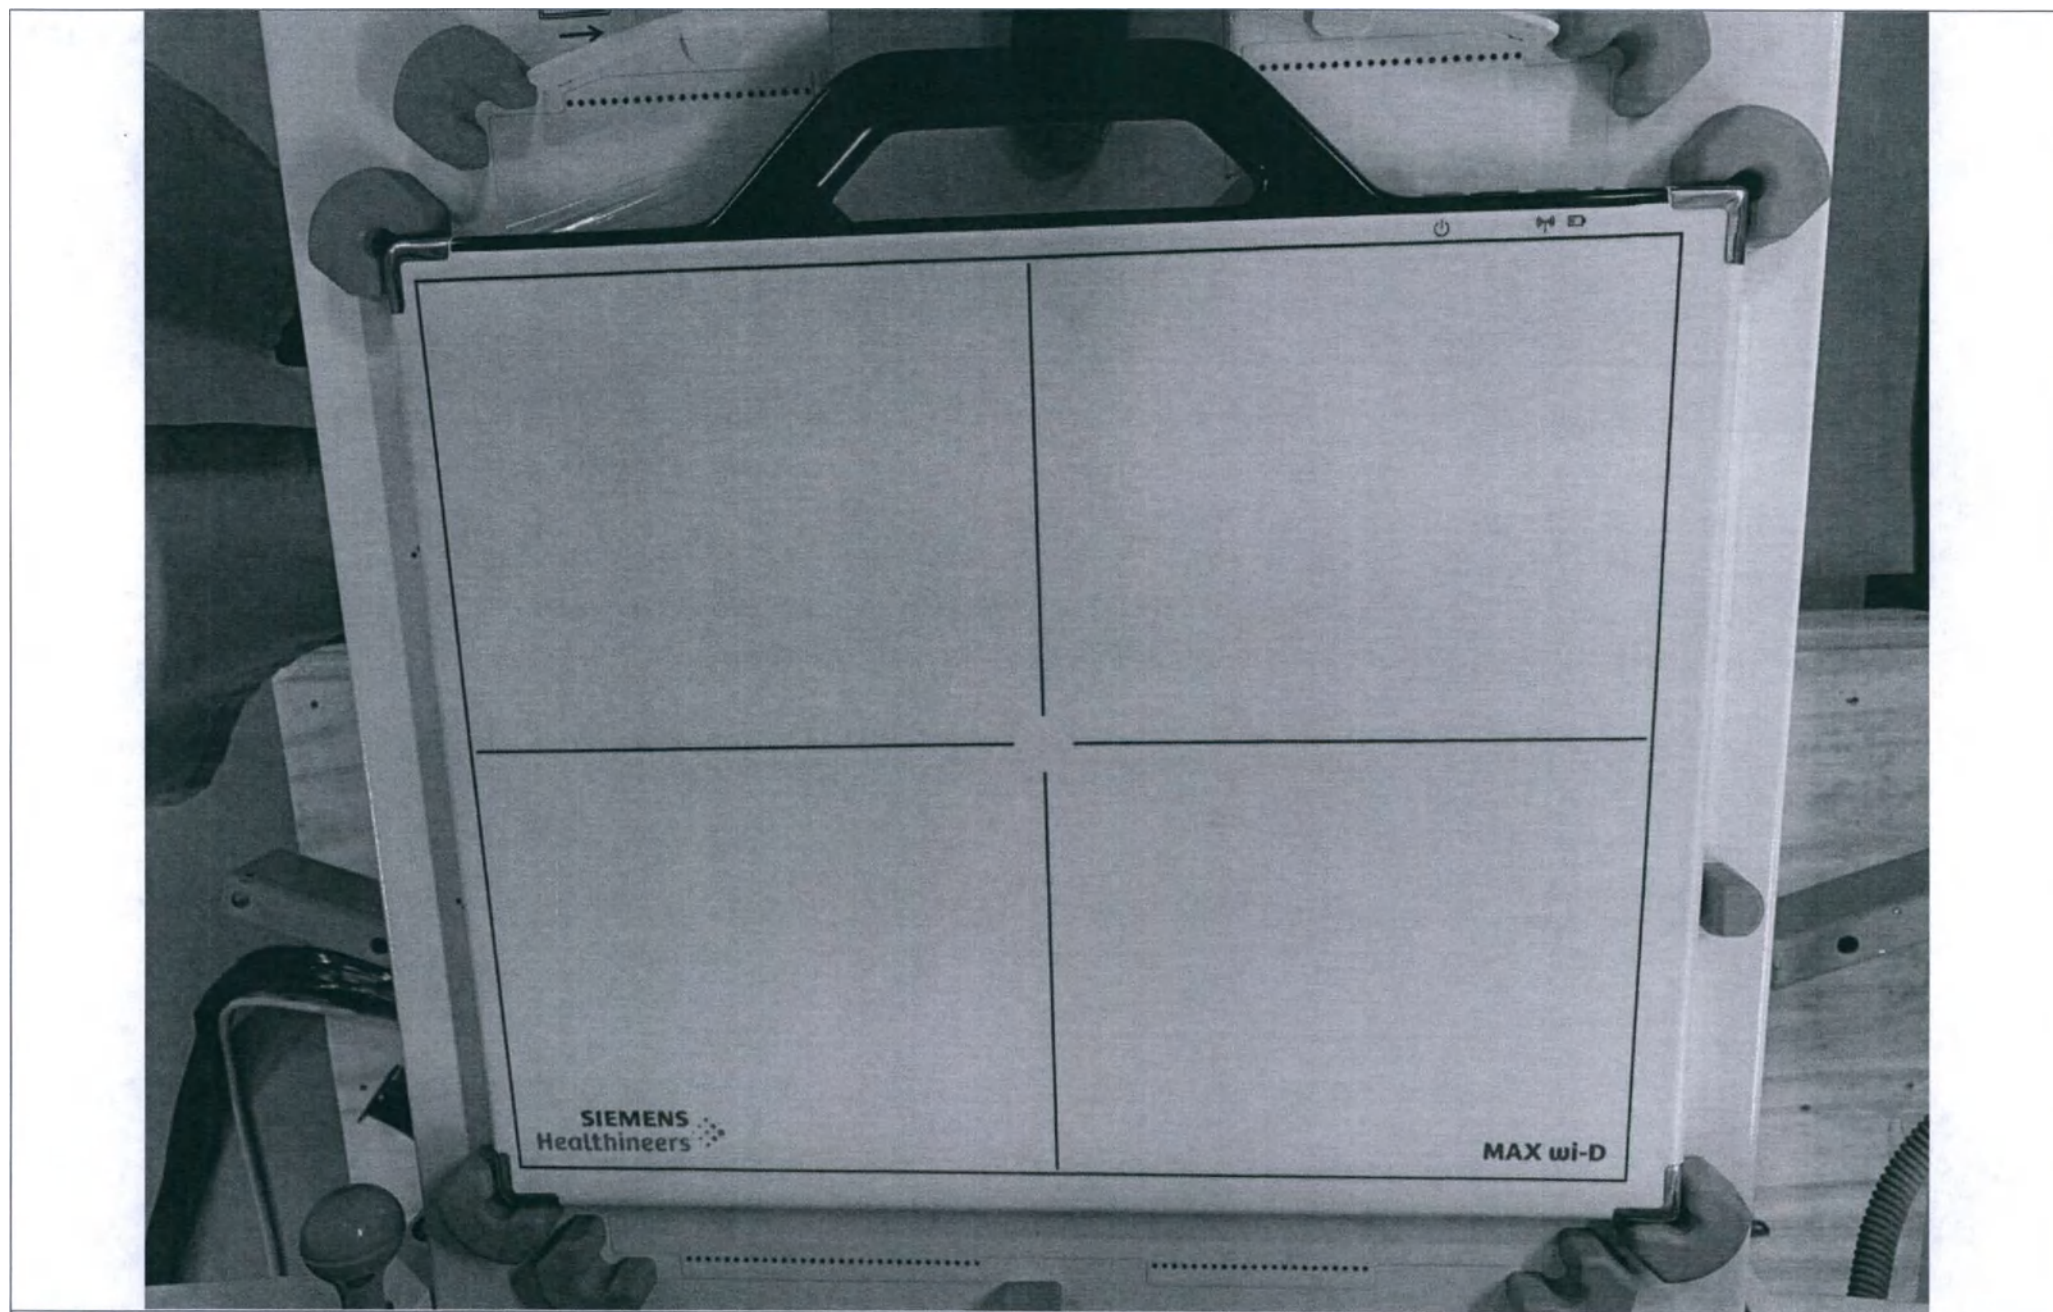


2.2 Беспроводной детектор MAX wi-D.

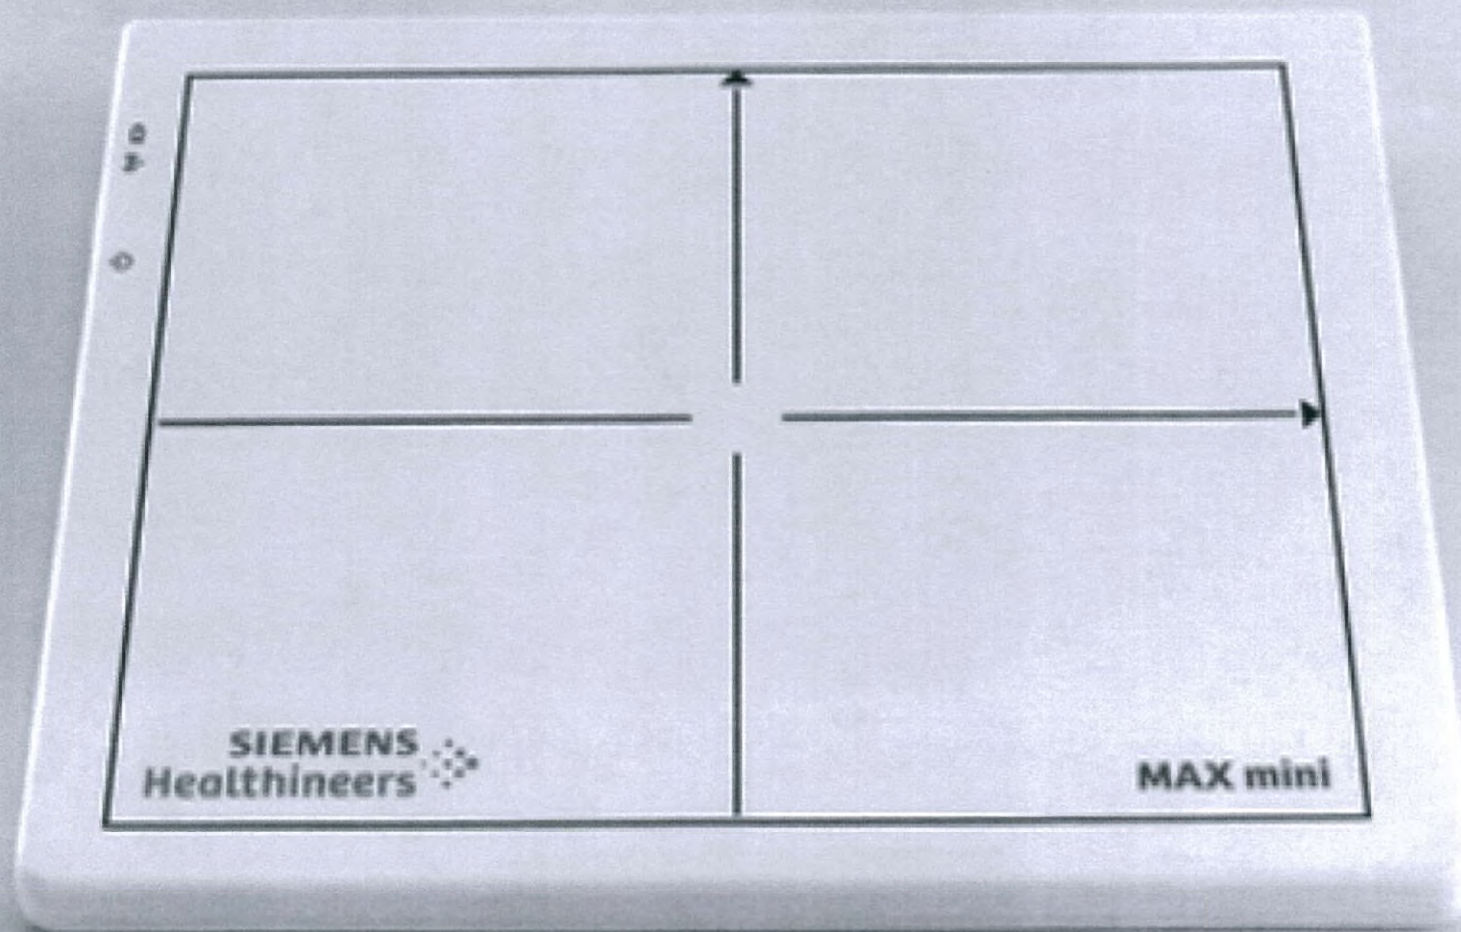


2.3 Беспроводной детектор MAX mini.

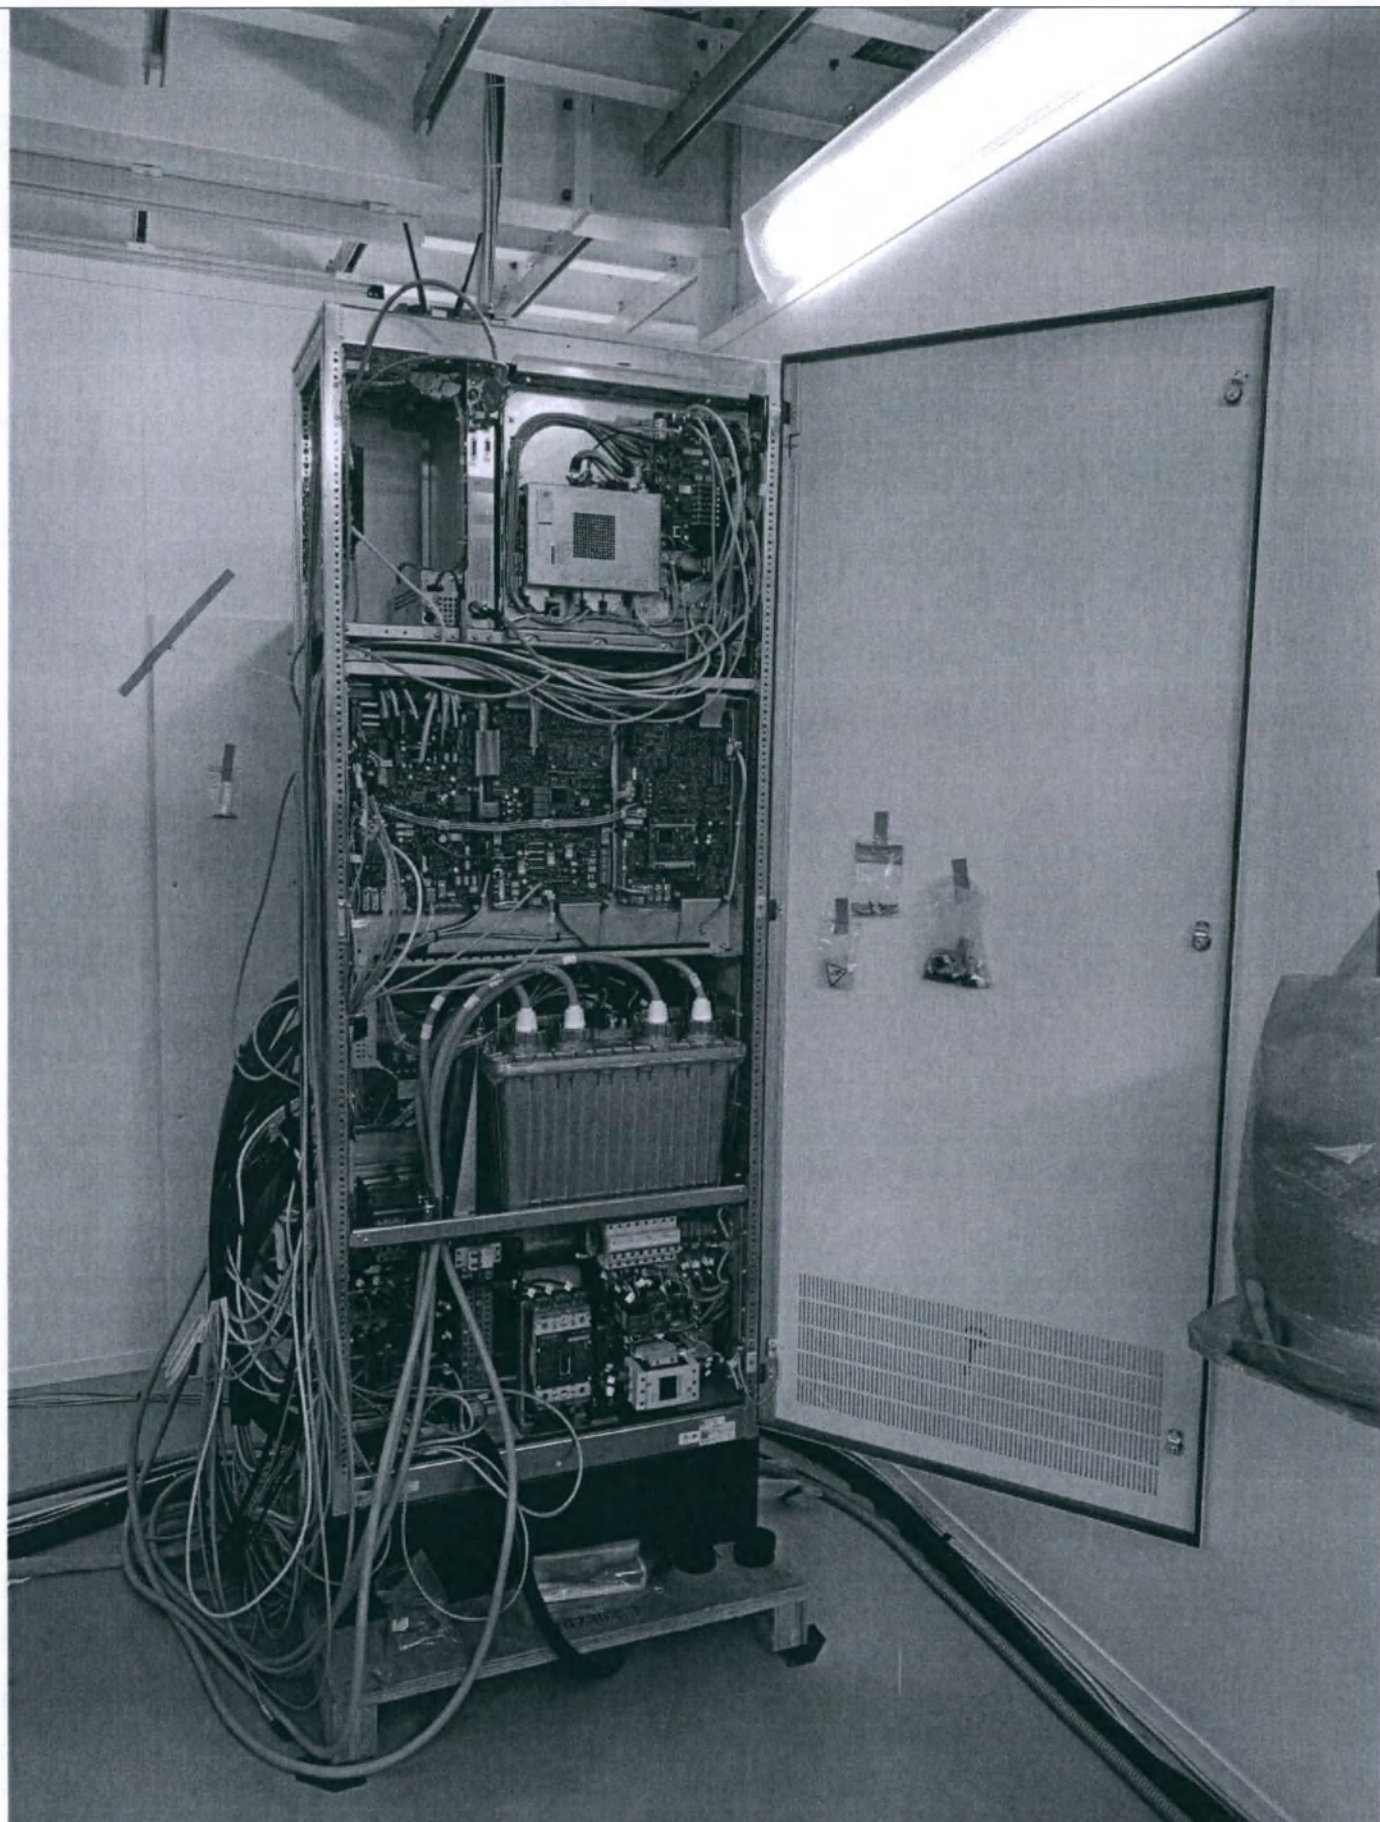


3. Генератор рентгеновский POLYDOROS F , варианты исполнения 65 кВт; 80 кВт.

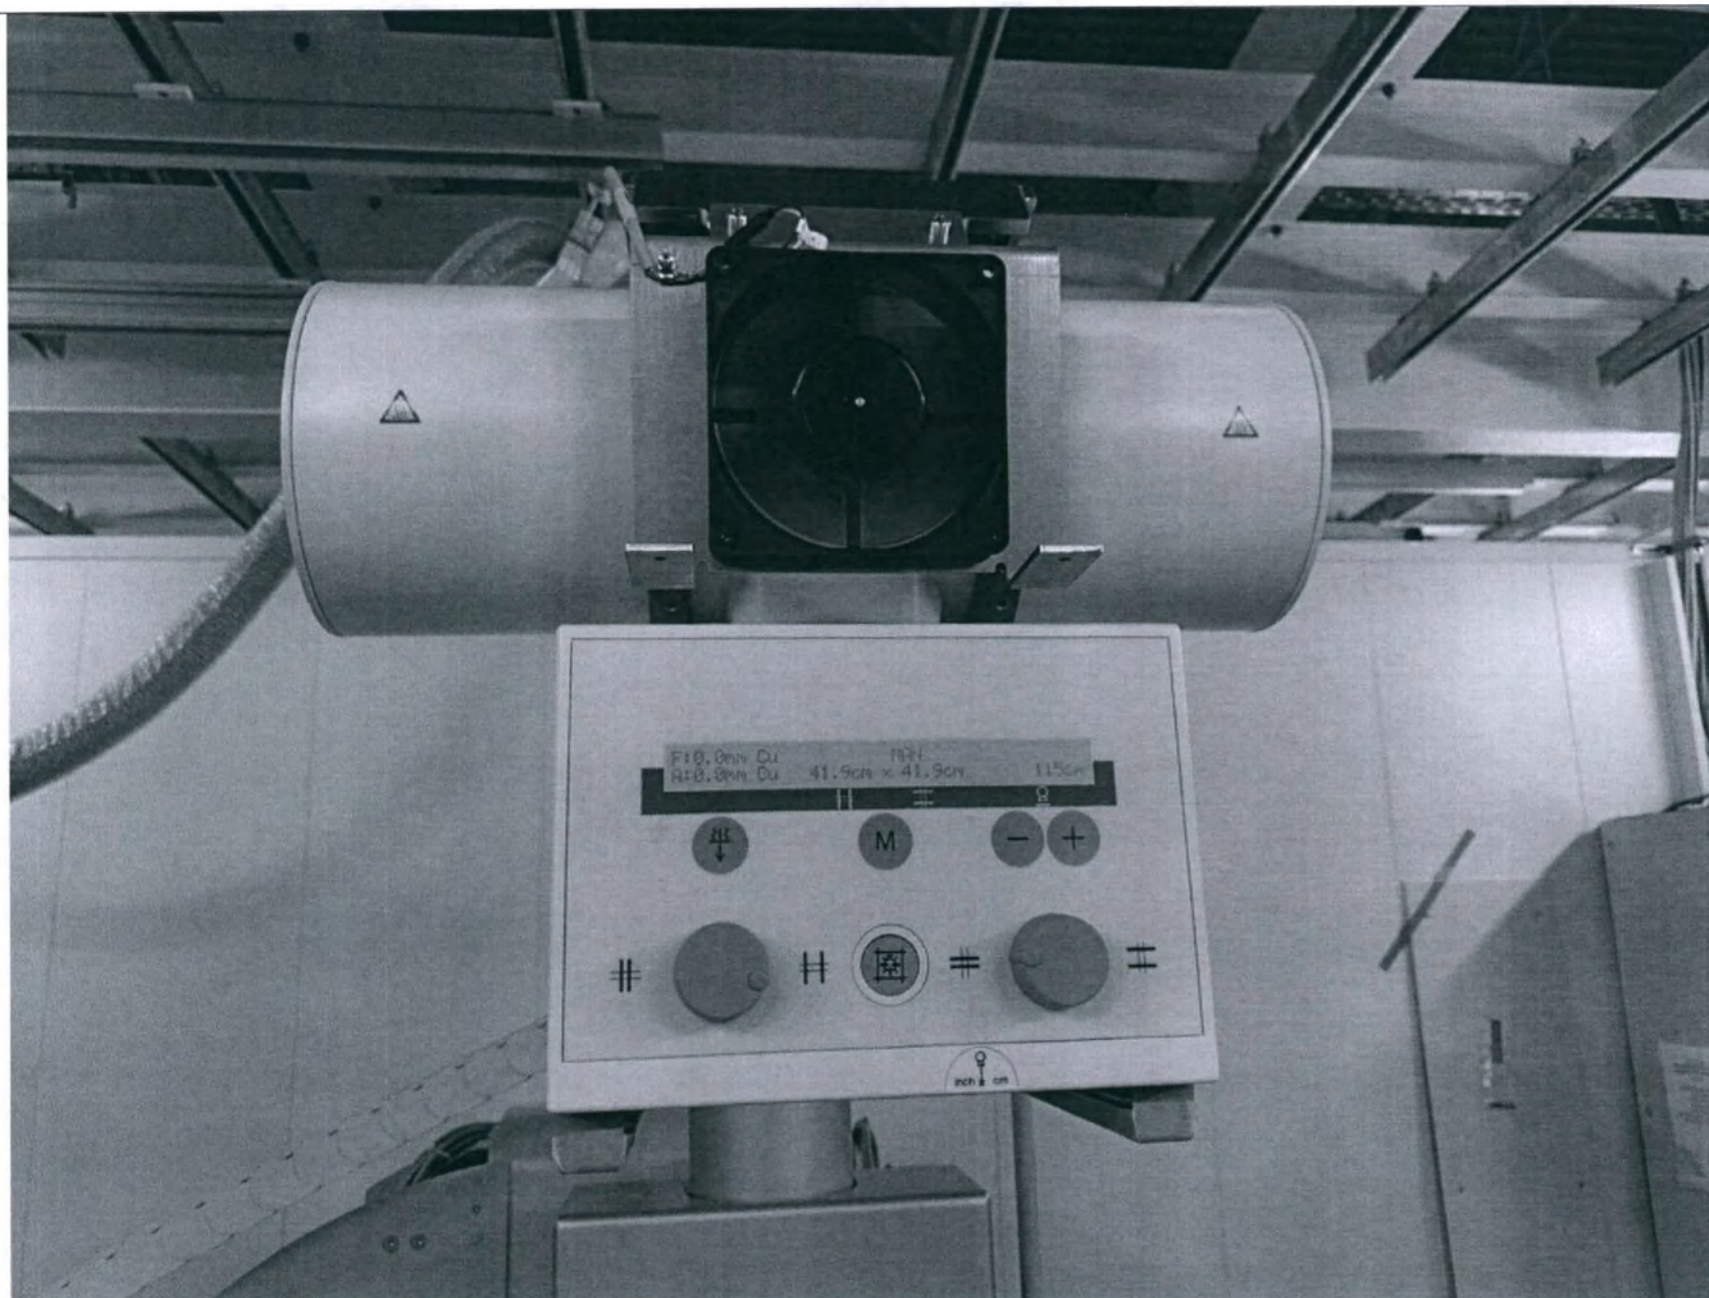


4. Рентгеновская трубка OPTITOR.

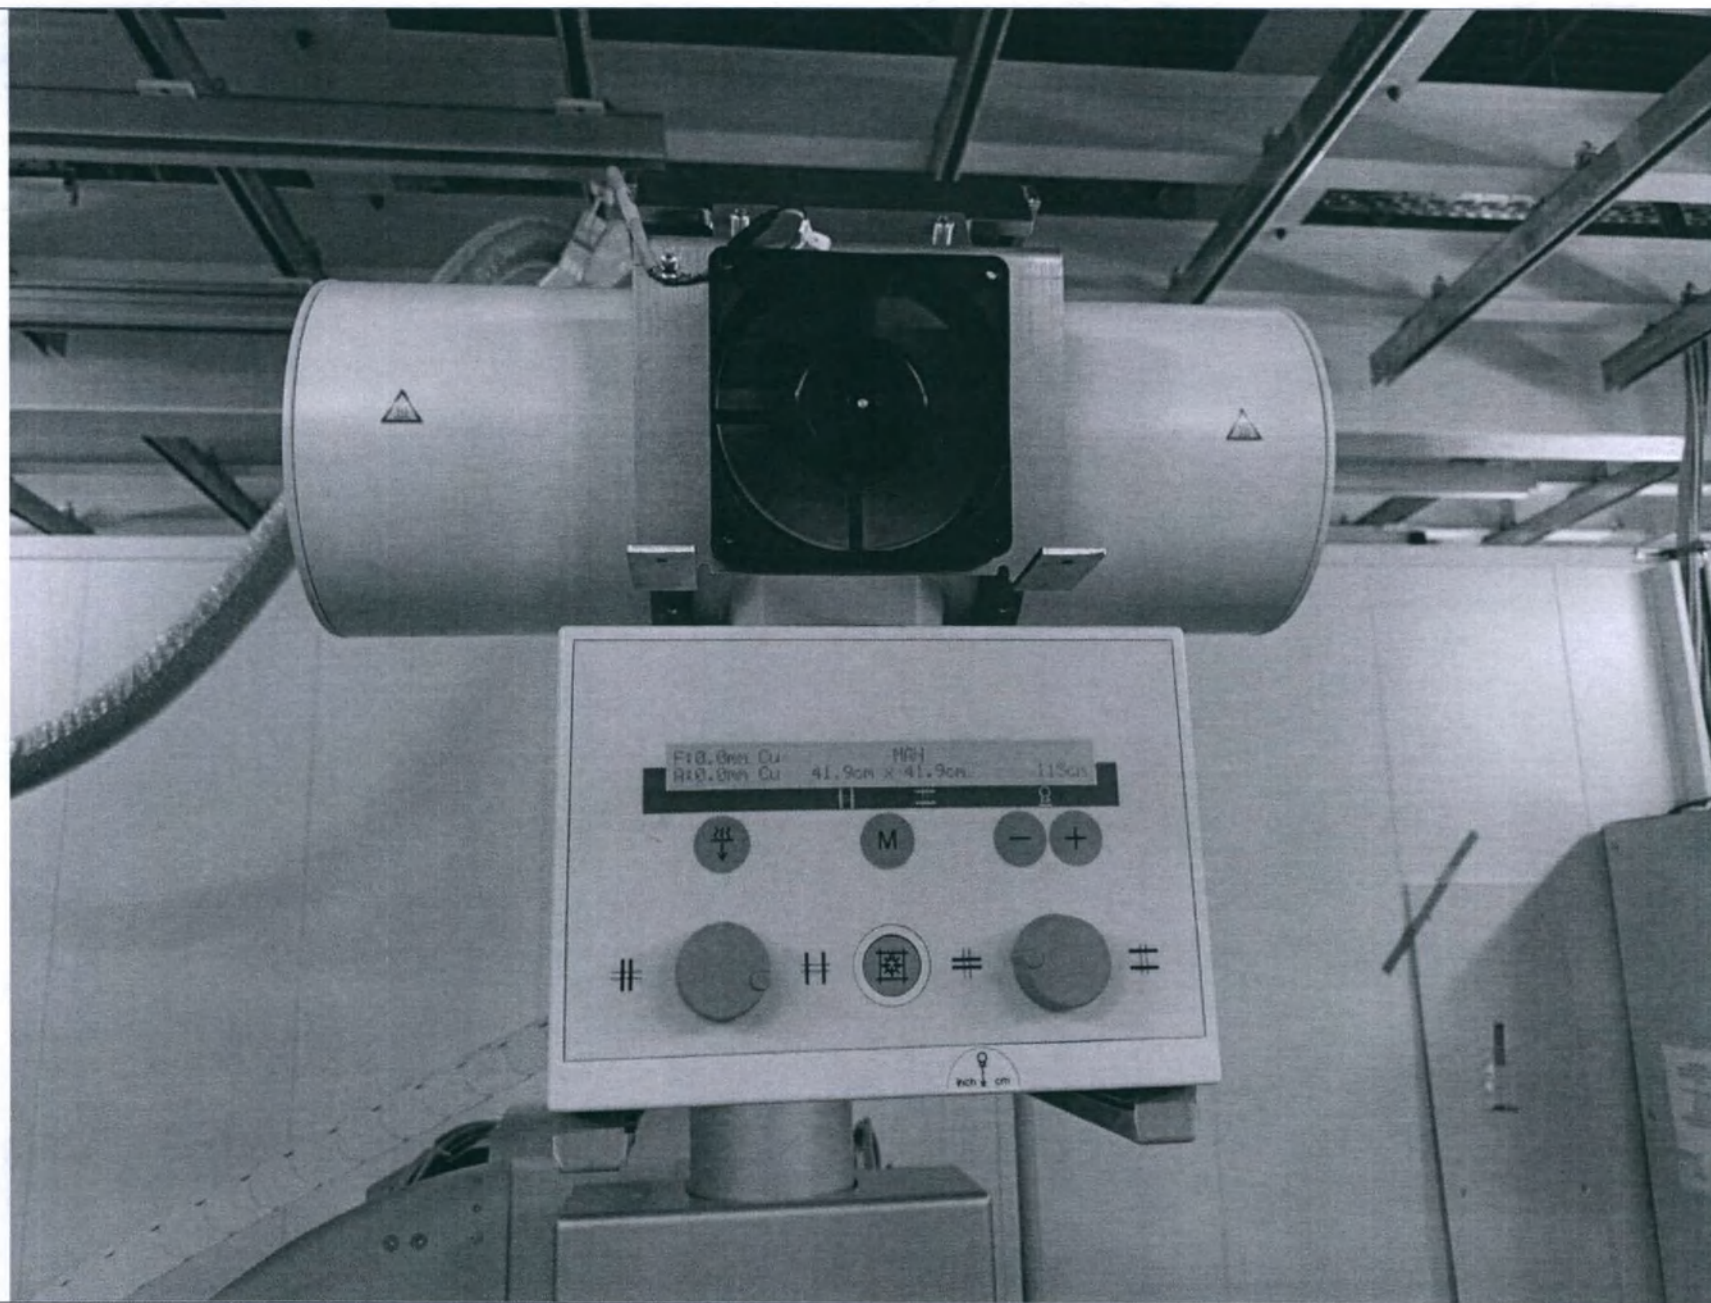

5. Многолепестковый коллиматор, варианты исполнения: -стандартный; -с полупрозрачными фильтрами.

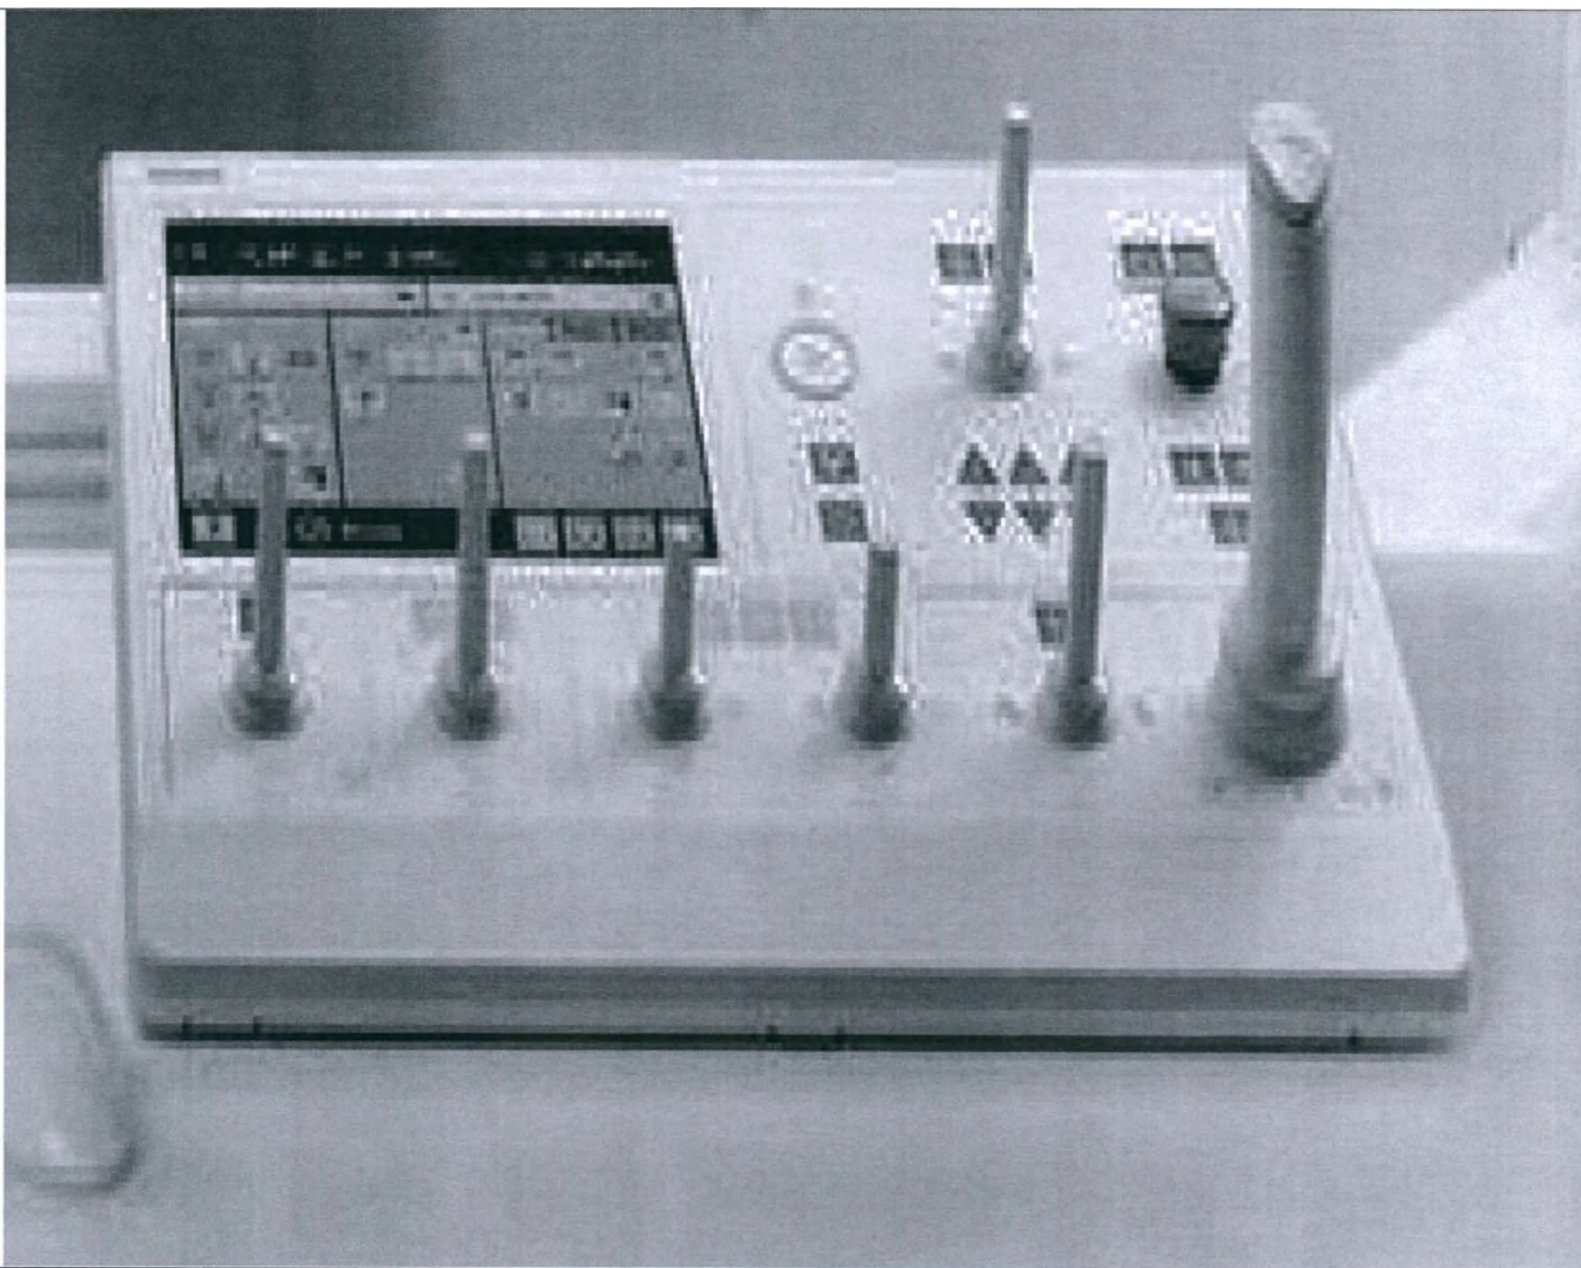


6. Дистанционный пульт управления системой.

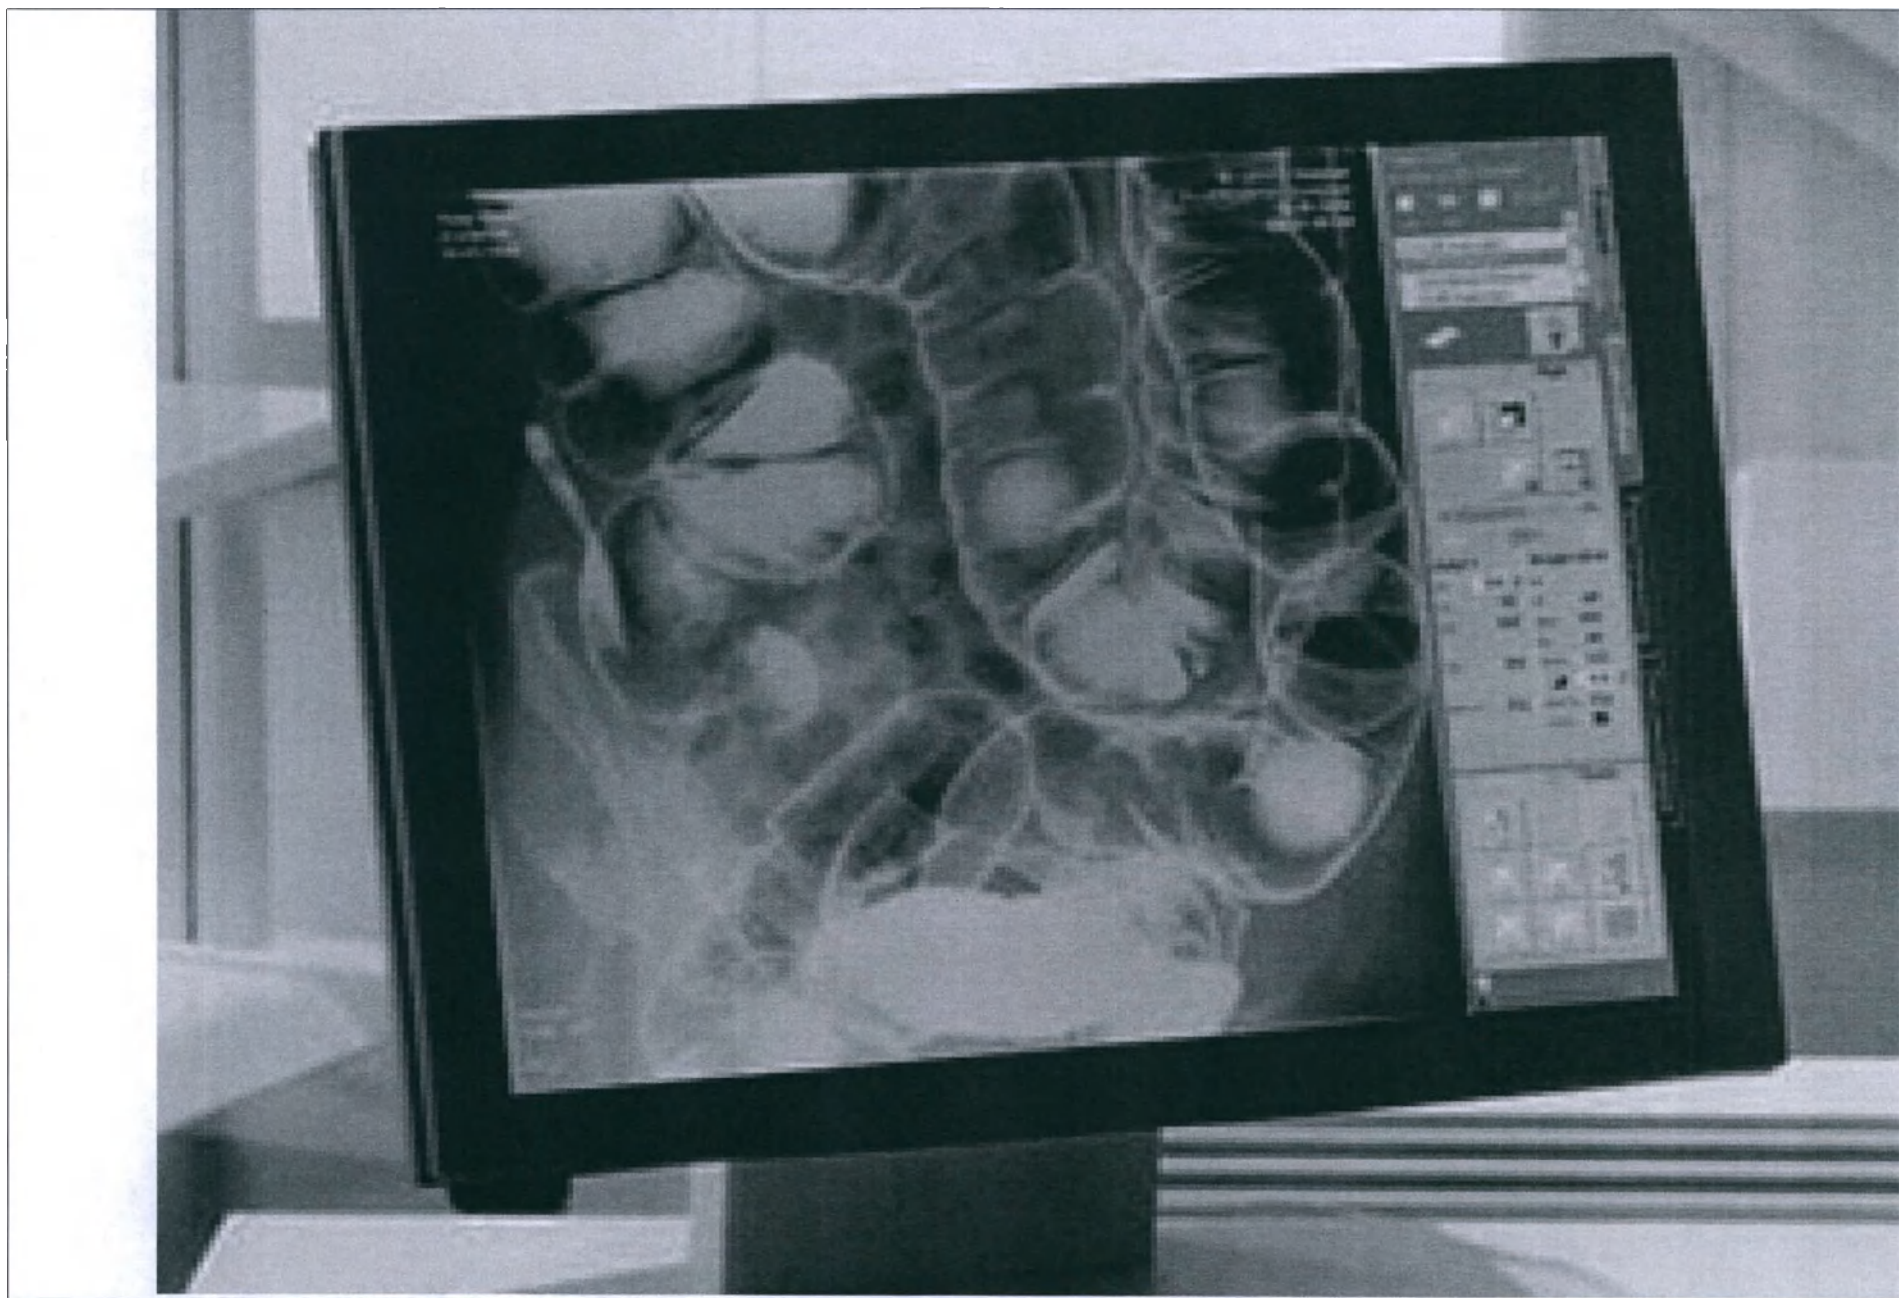


7. Дисплей для пультовой.




8.1 Система формирования изображений FLUOROSPOT Compact с базовым программным обеспечением, мышью и клавиатурой.

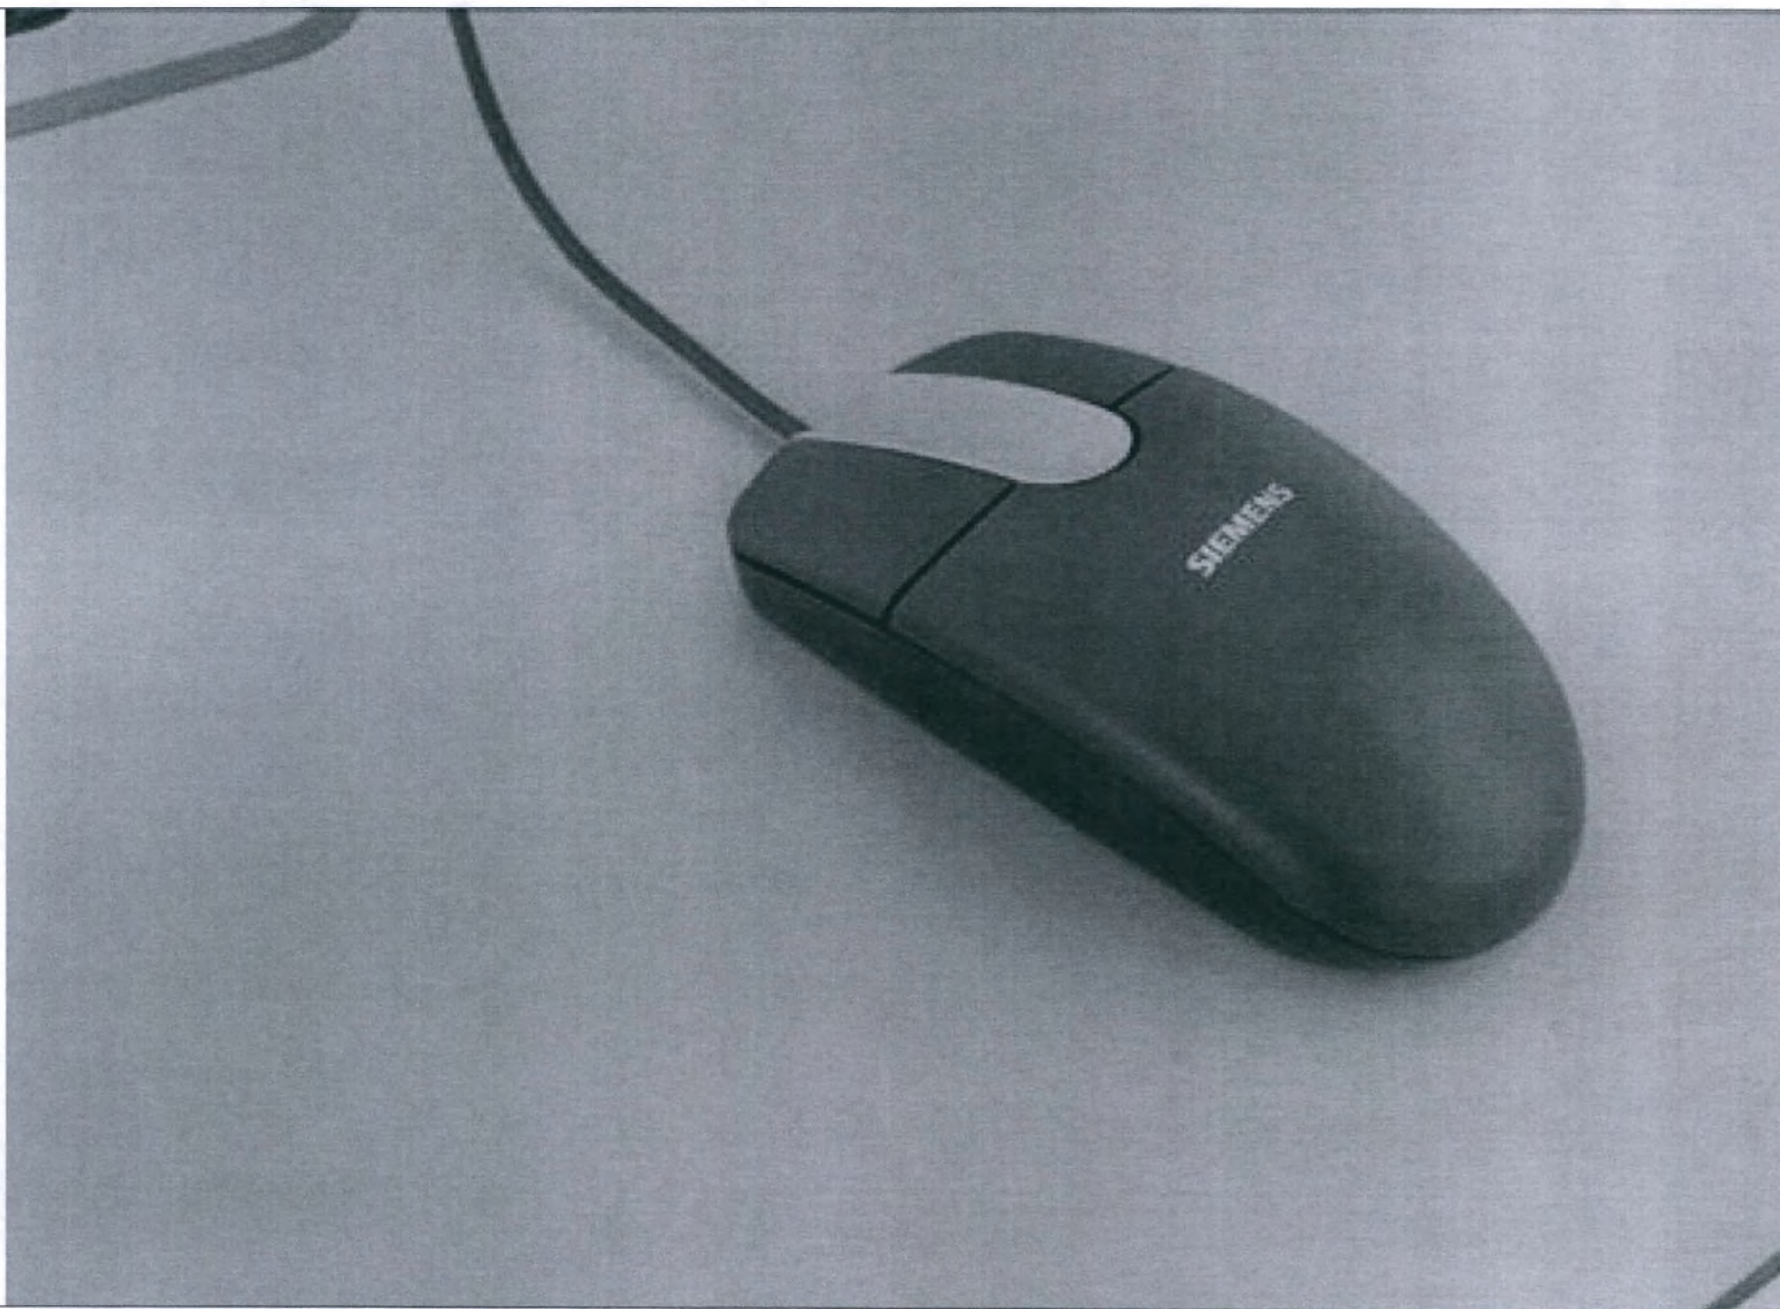


8.2 Система формирования изображений FLUOROSPOT Compact с базовым программным обеспечением, мышью и клавиатурой.

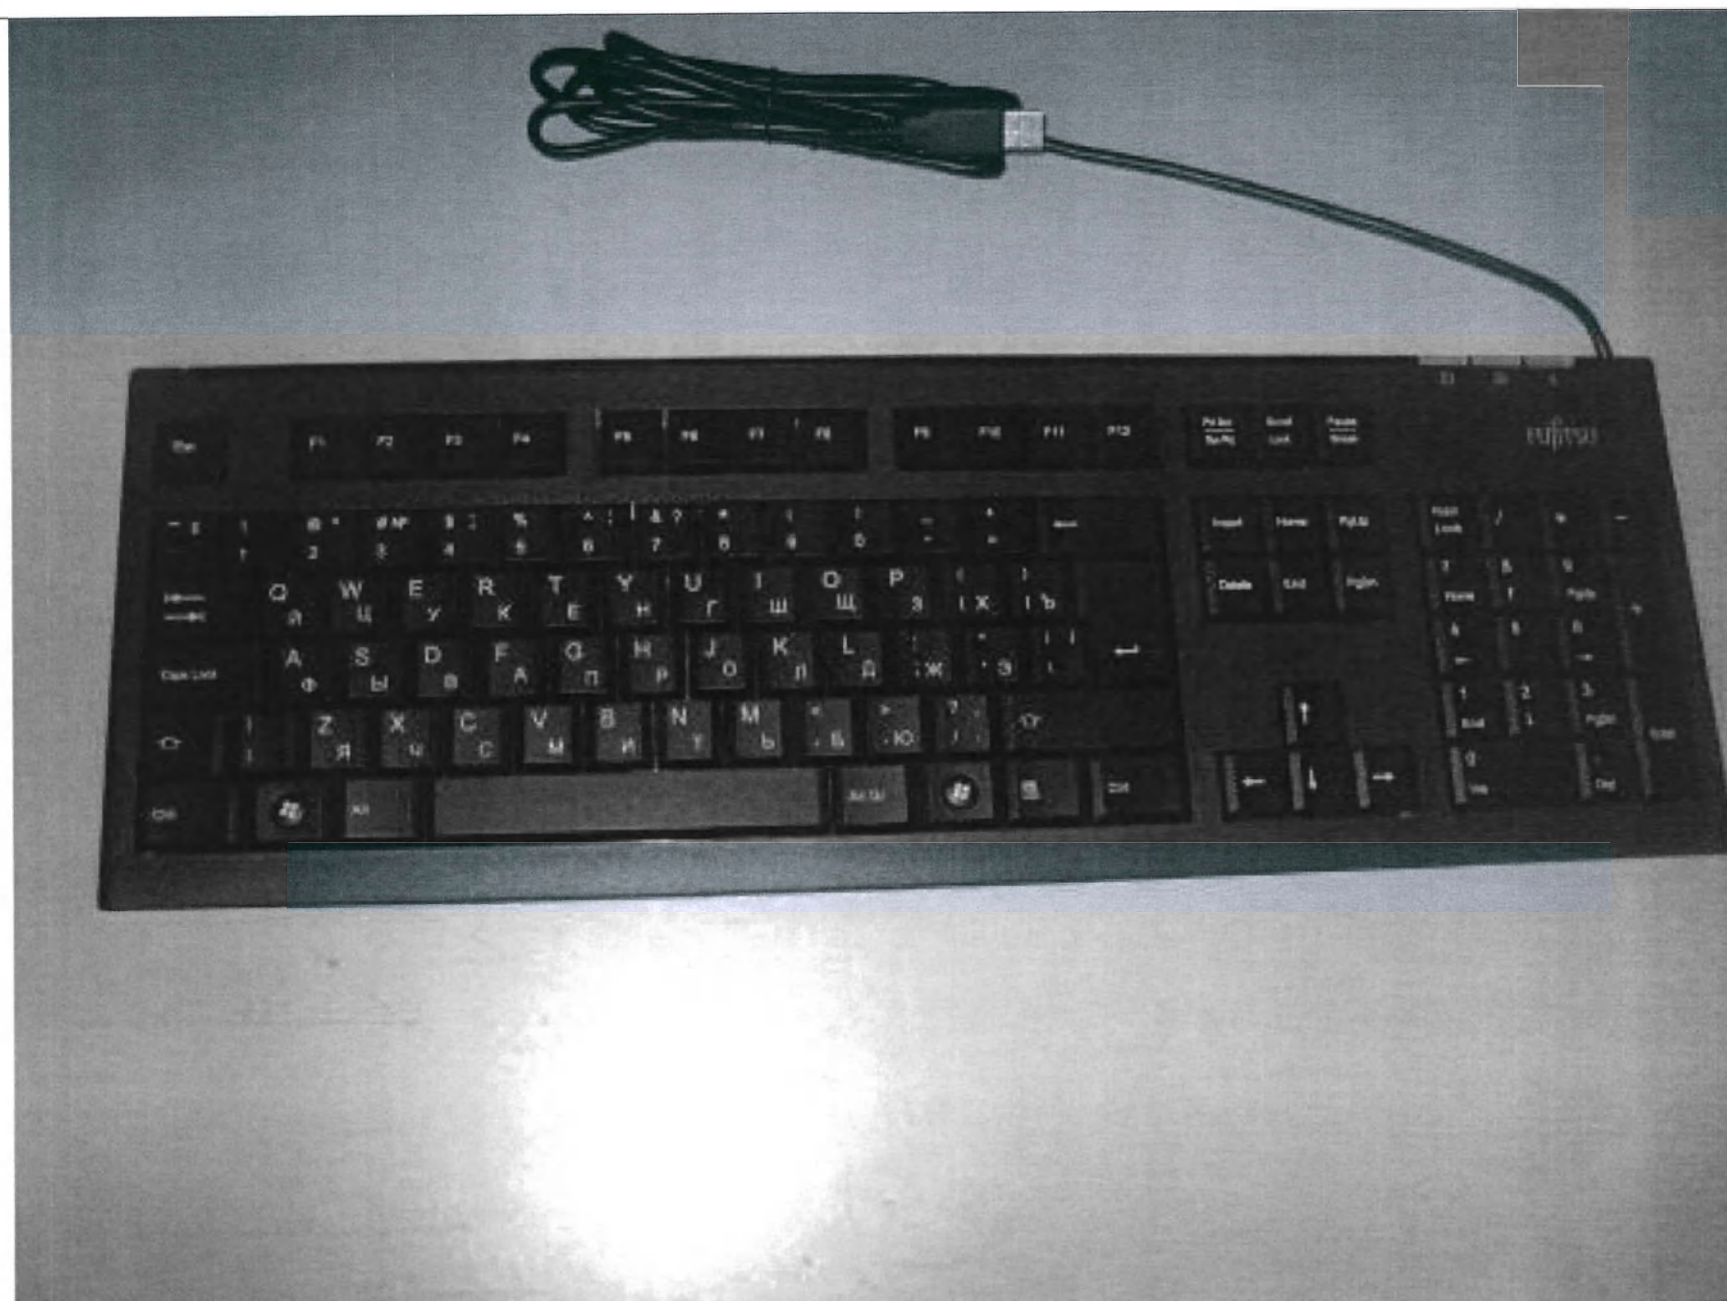

8.3 Система формирования изображений FLUOROSPOT Compact с базовым программным обеспечением, мышью и клавиатурой.

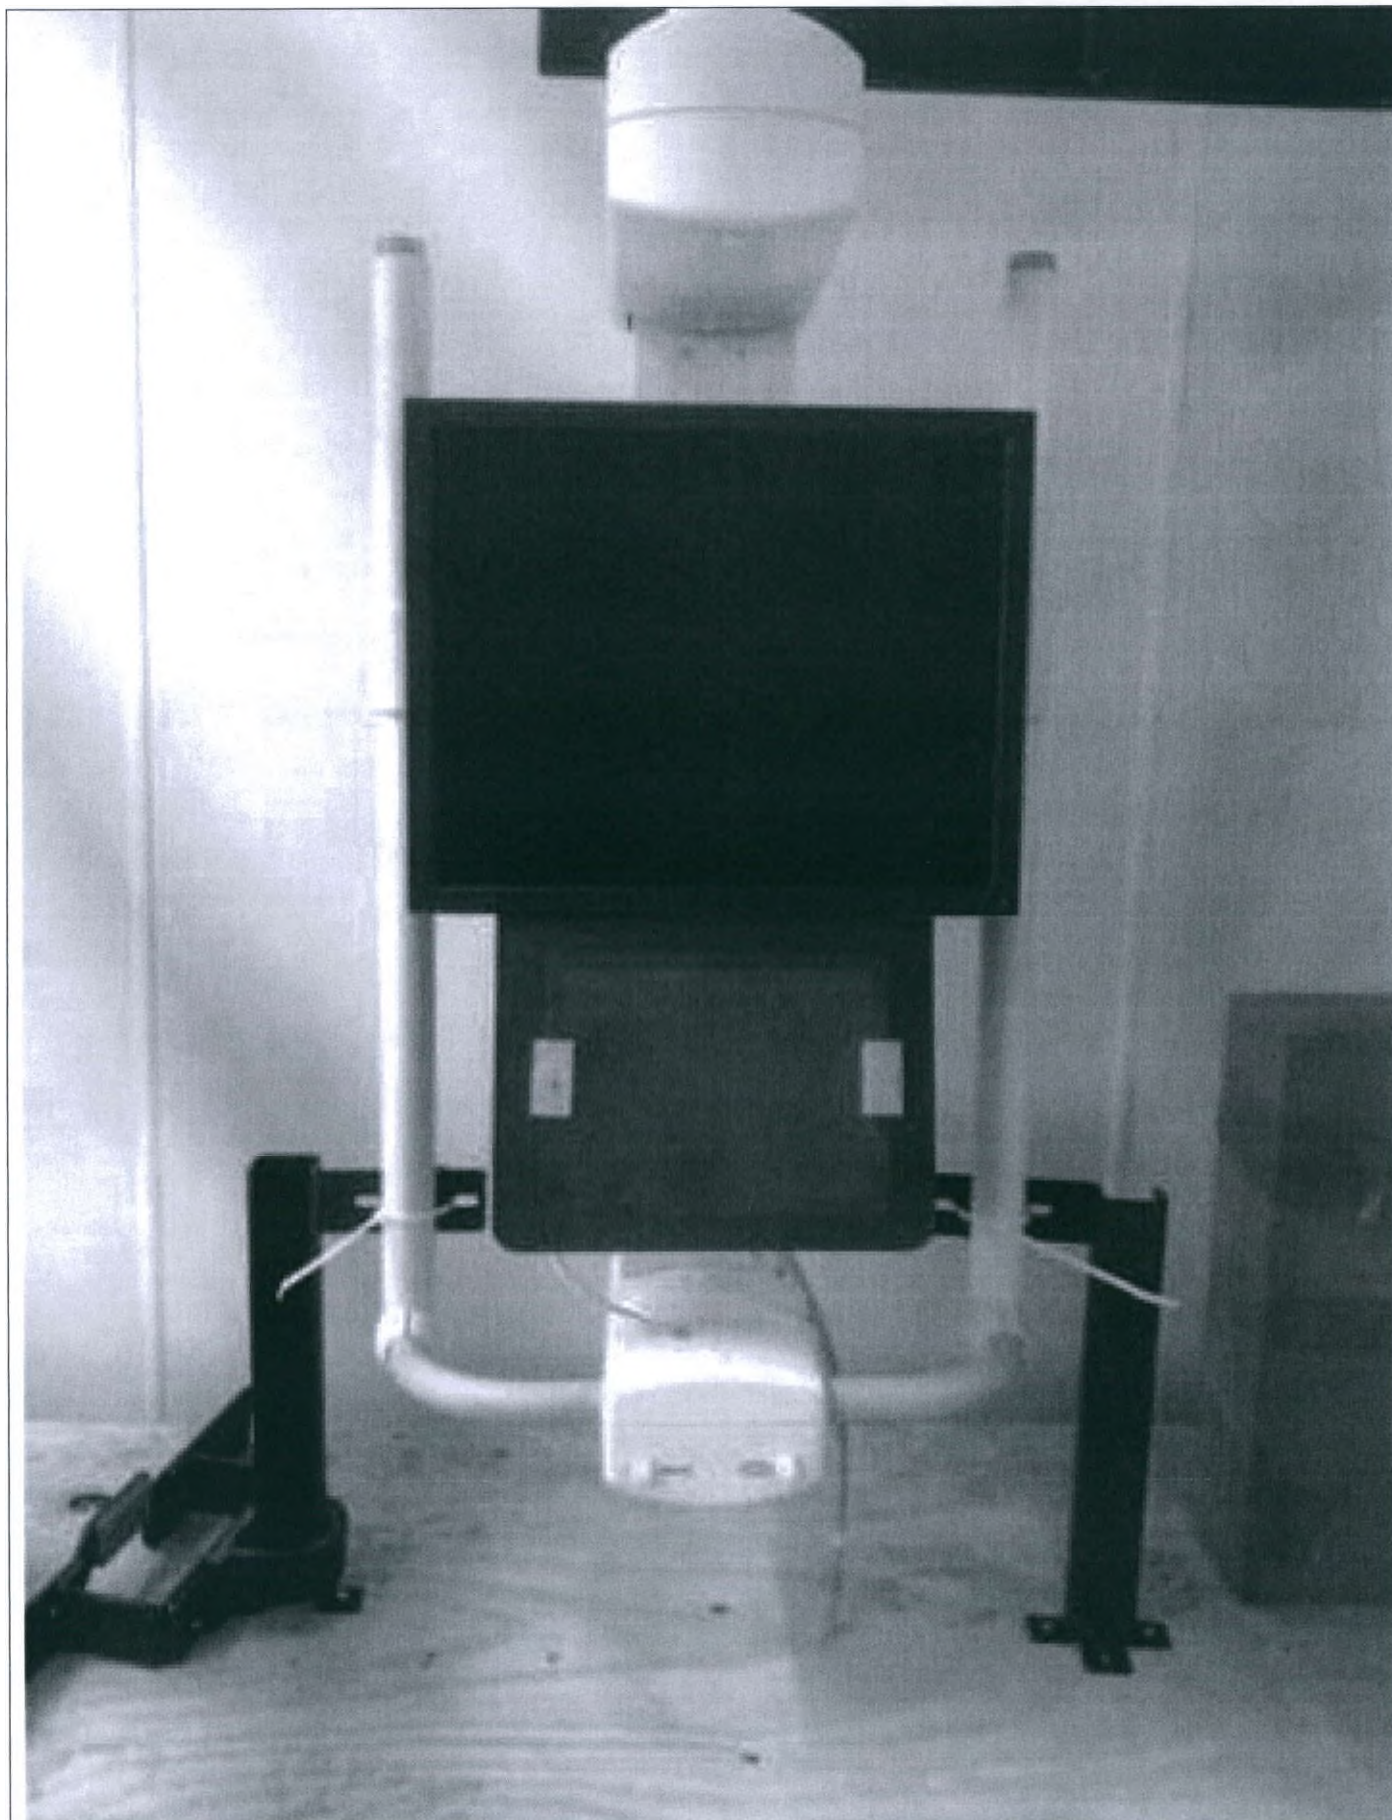

9.2 Потолочная подвеска с одним или двумя дисплеями.

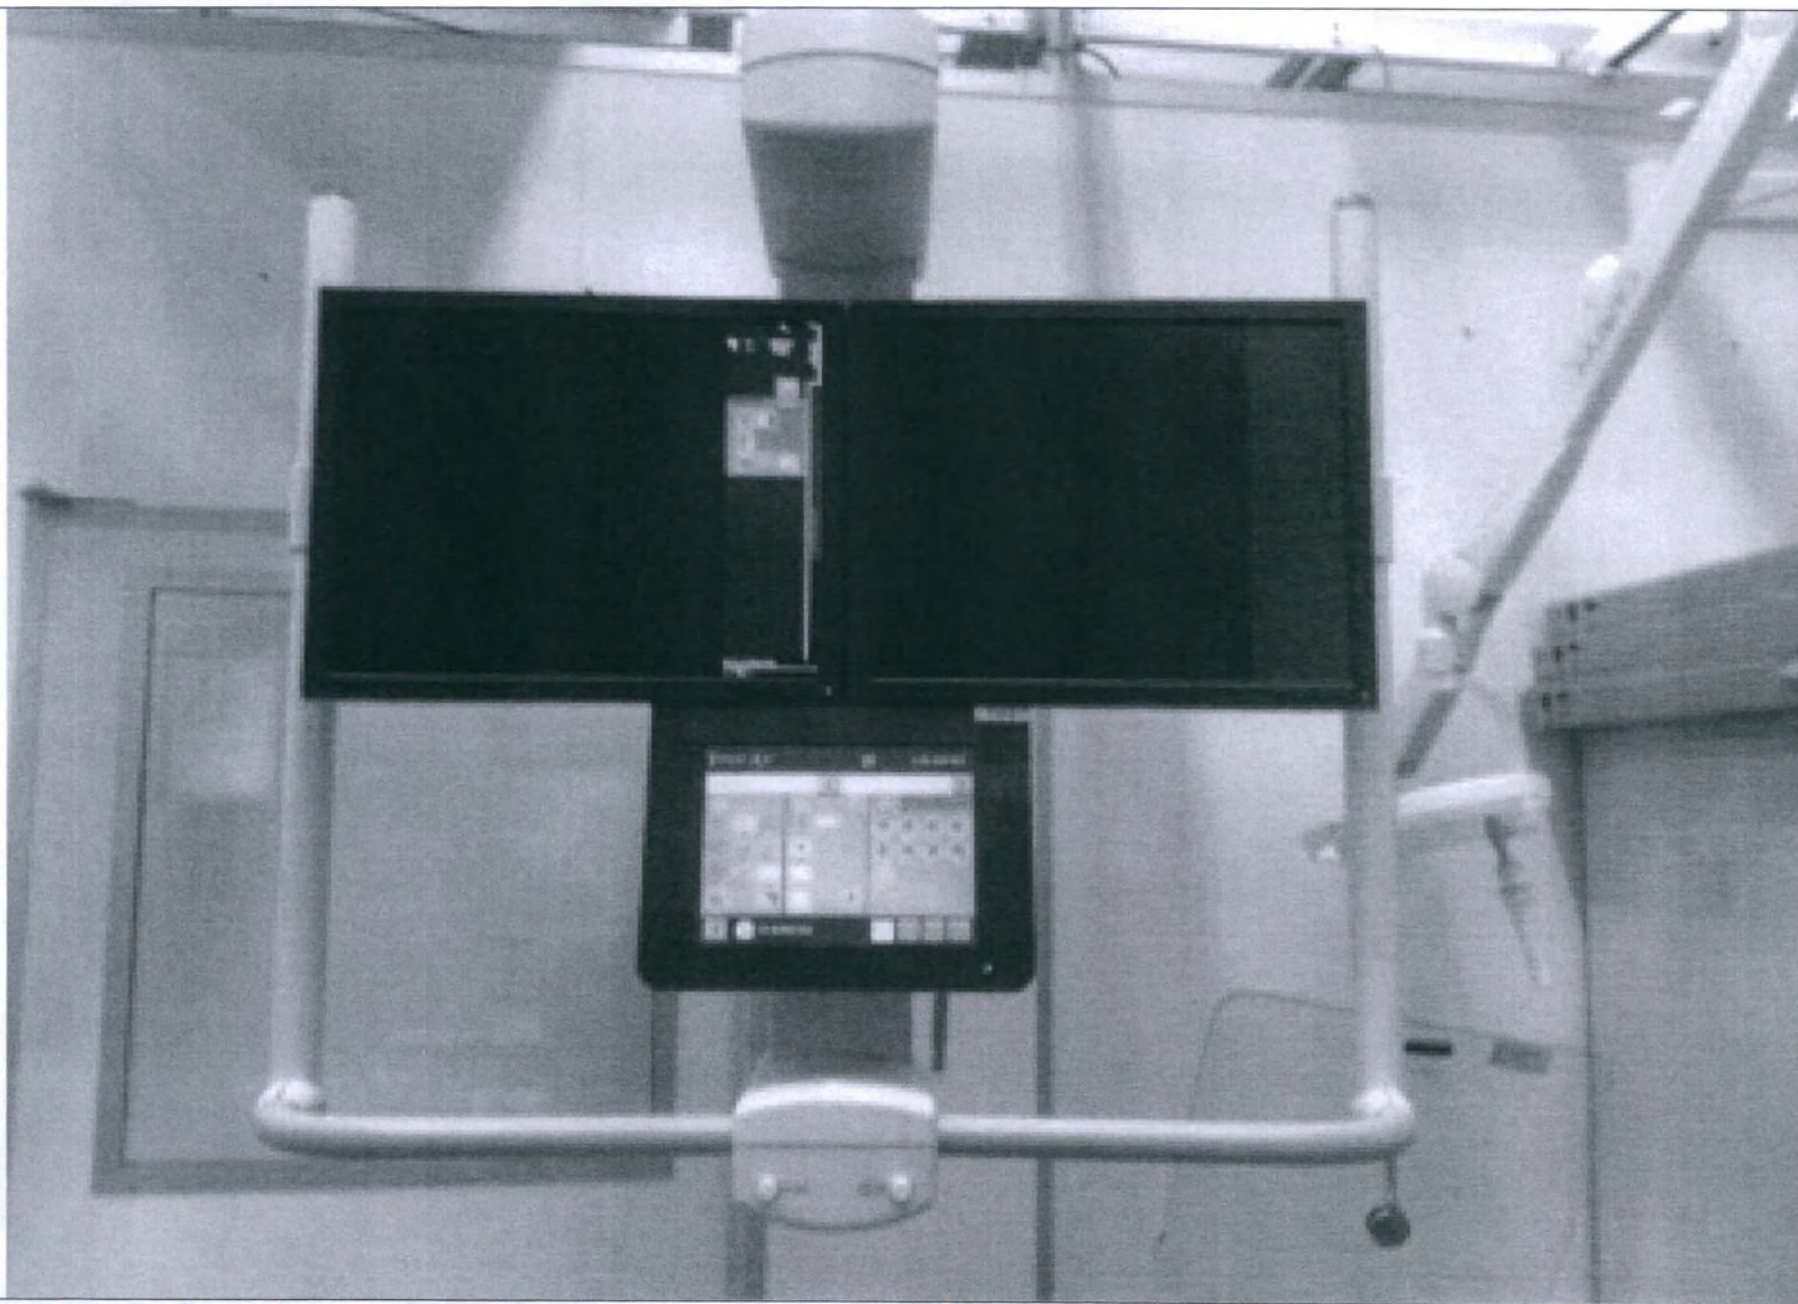


9.3 Потолочная подвеска с одним или двумя дисплеями




10. Педальный переключатель для рентгеноскопии и рентгенографии.




11. Устройство измерения суммарной поверхностной дозы.

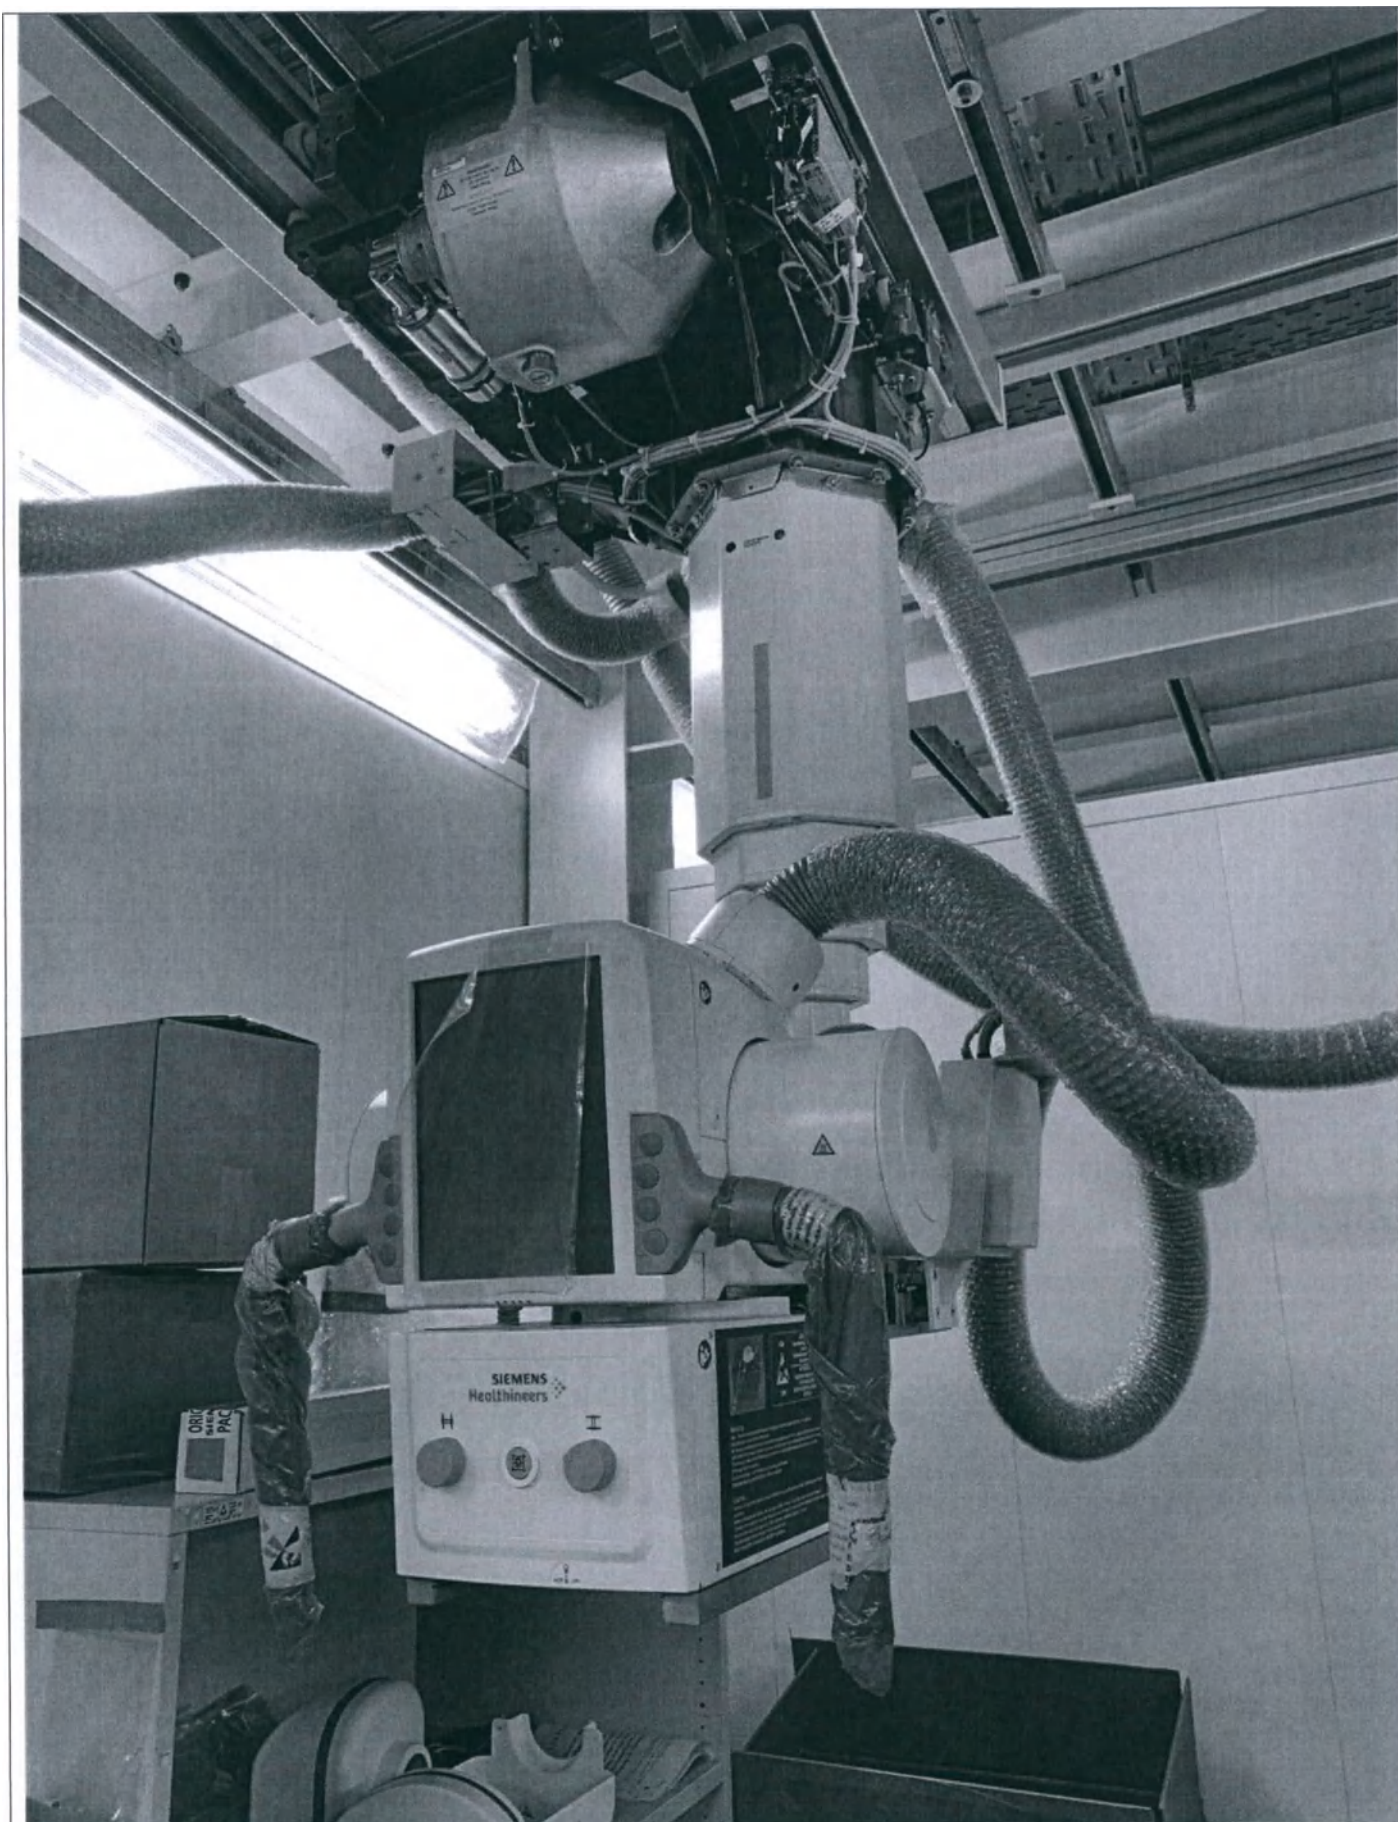

12. Потолочный 3D-штатив с рентгеновской трубкой.

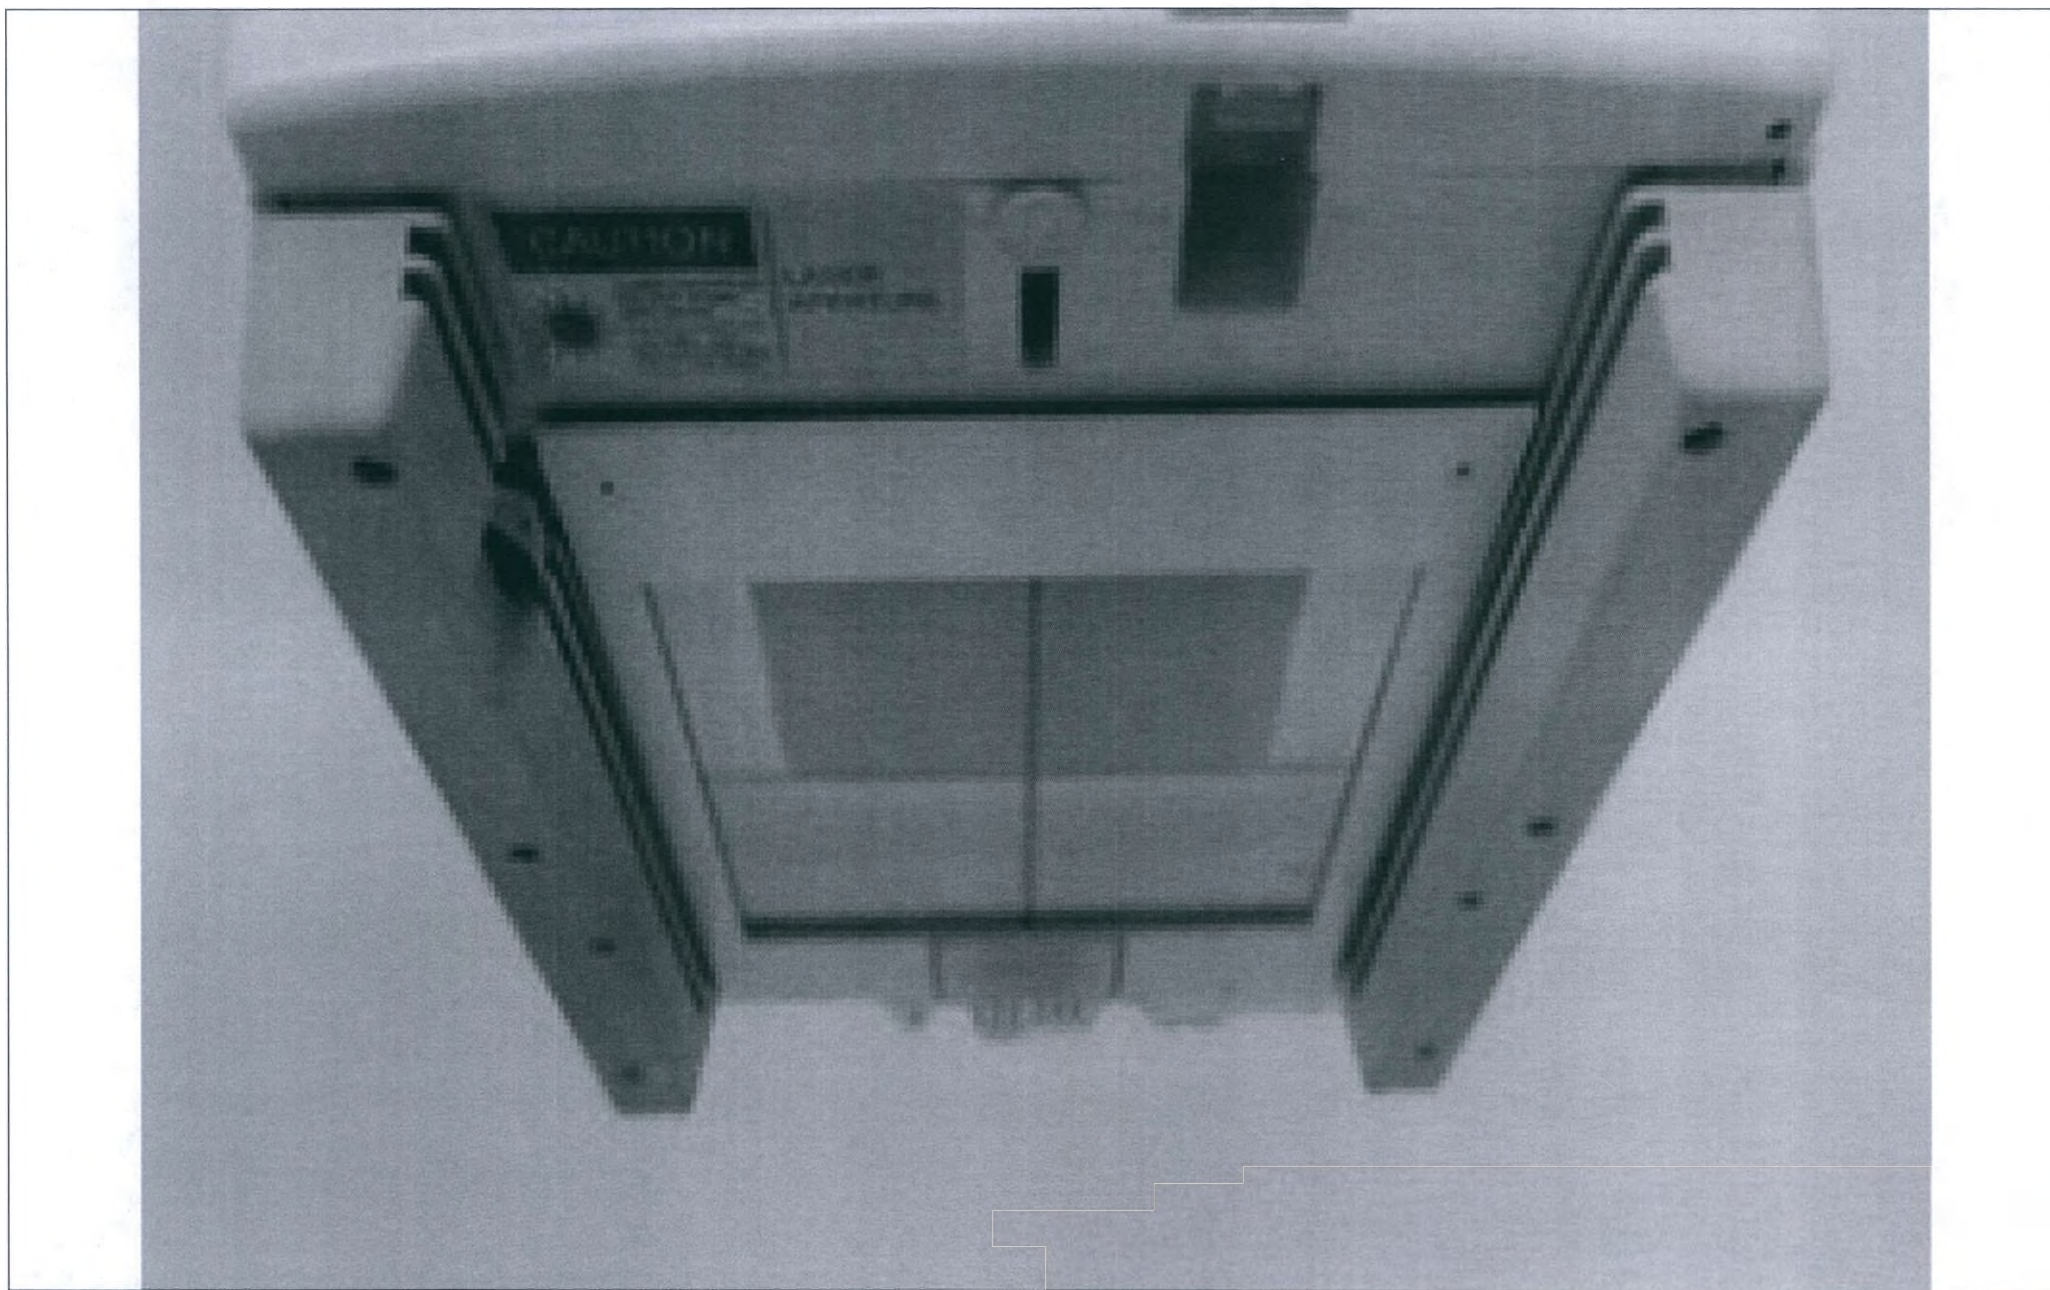

13. Устройство измерения суммарной поверхностной дозы для трубки с потолочным креплением.

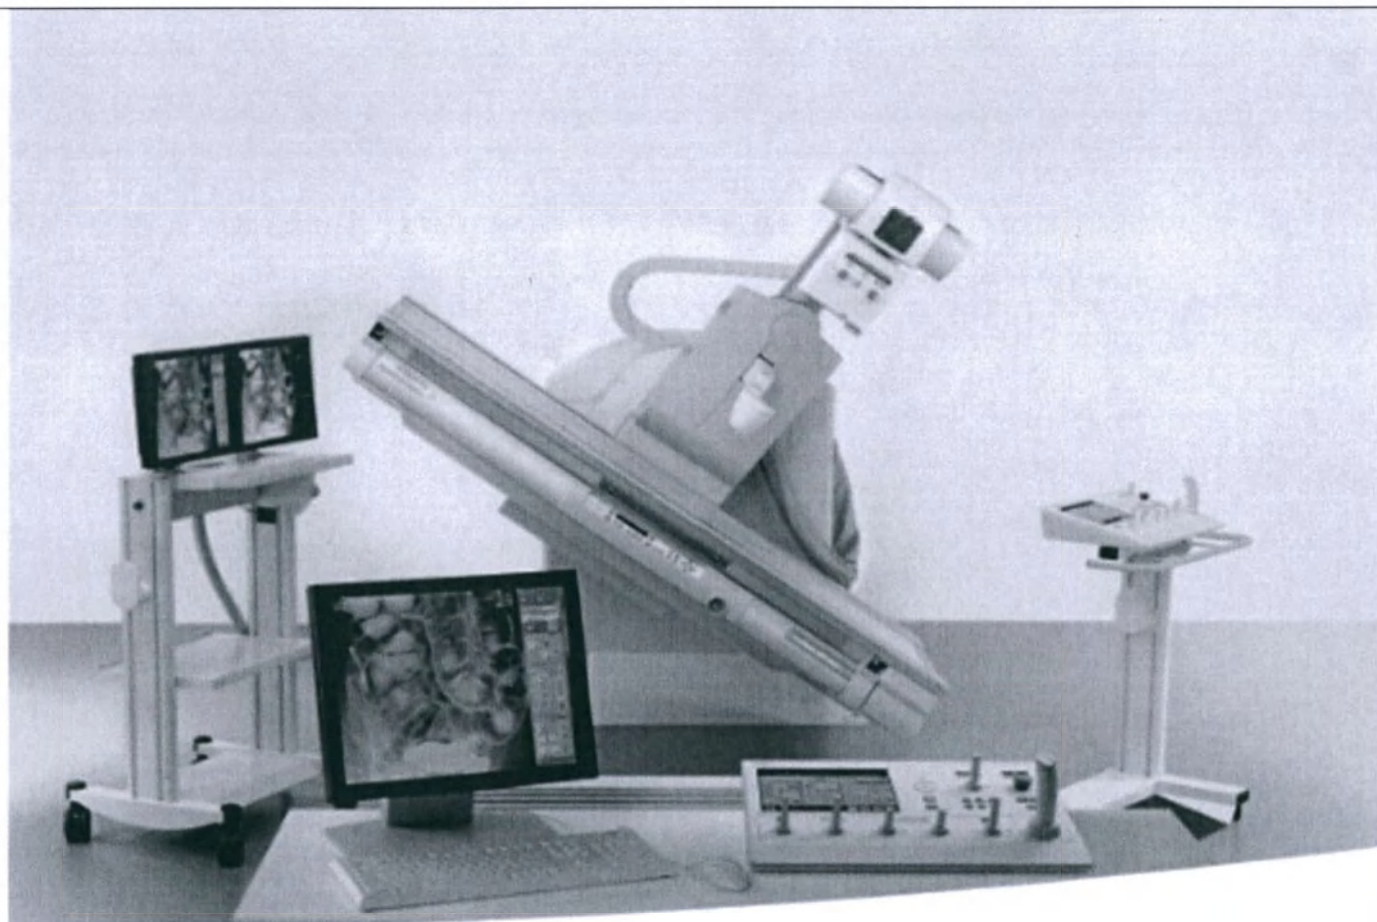


Luminos dRF Max

Руководство пользователя – VF11 и более поздние версии

siemens-healthineers.com


SIEMENS
Healthineers

4.14. Документация пользователя на русском языке.

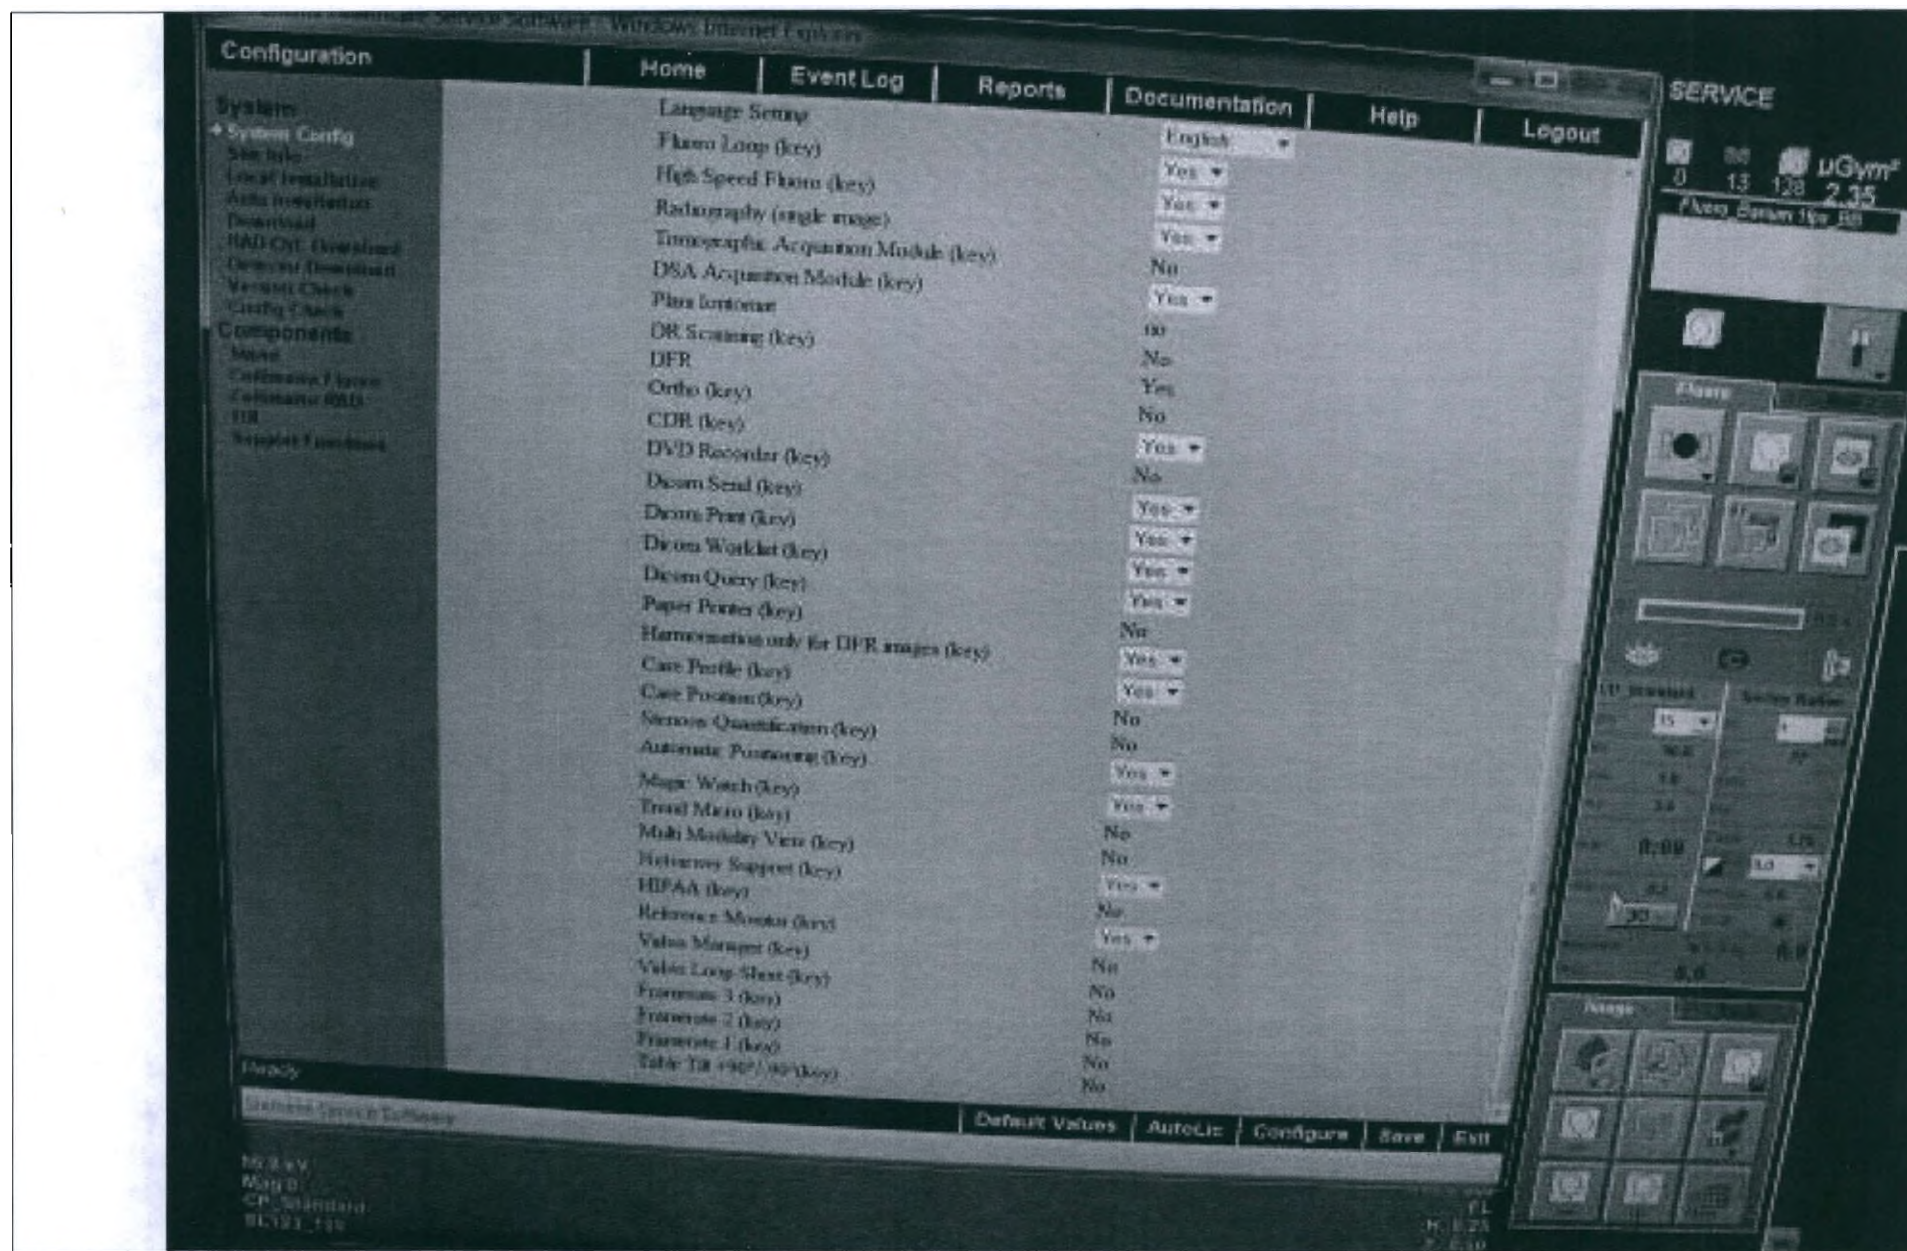


Принадлежности


1. Лицензионный ключ для активации программного режима наклона стола до -90.

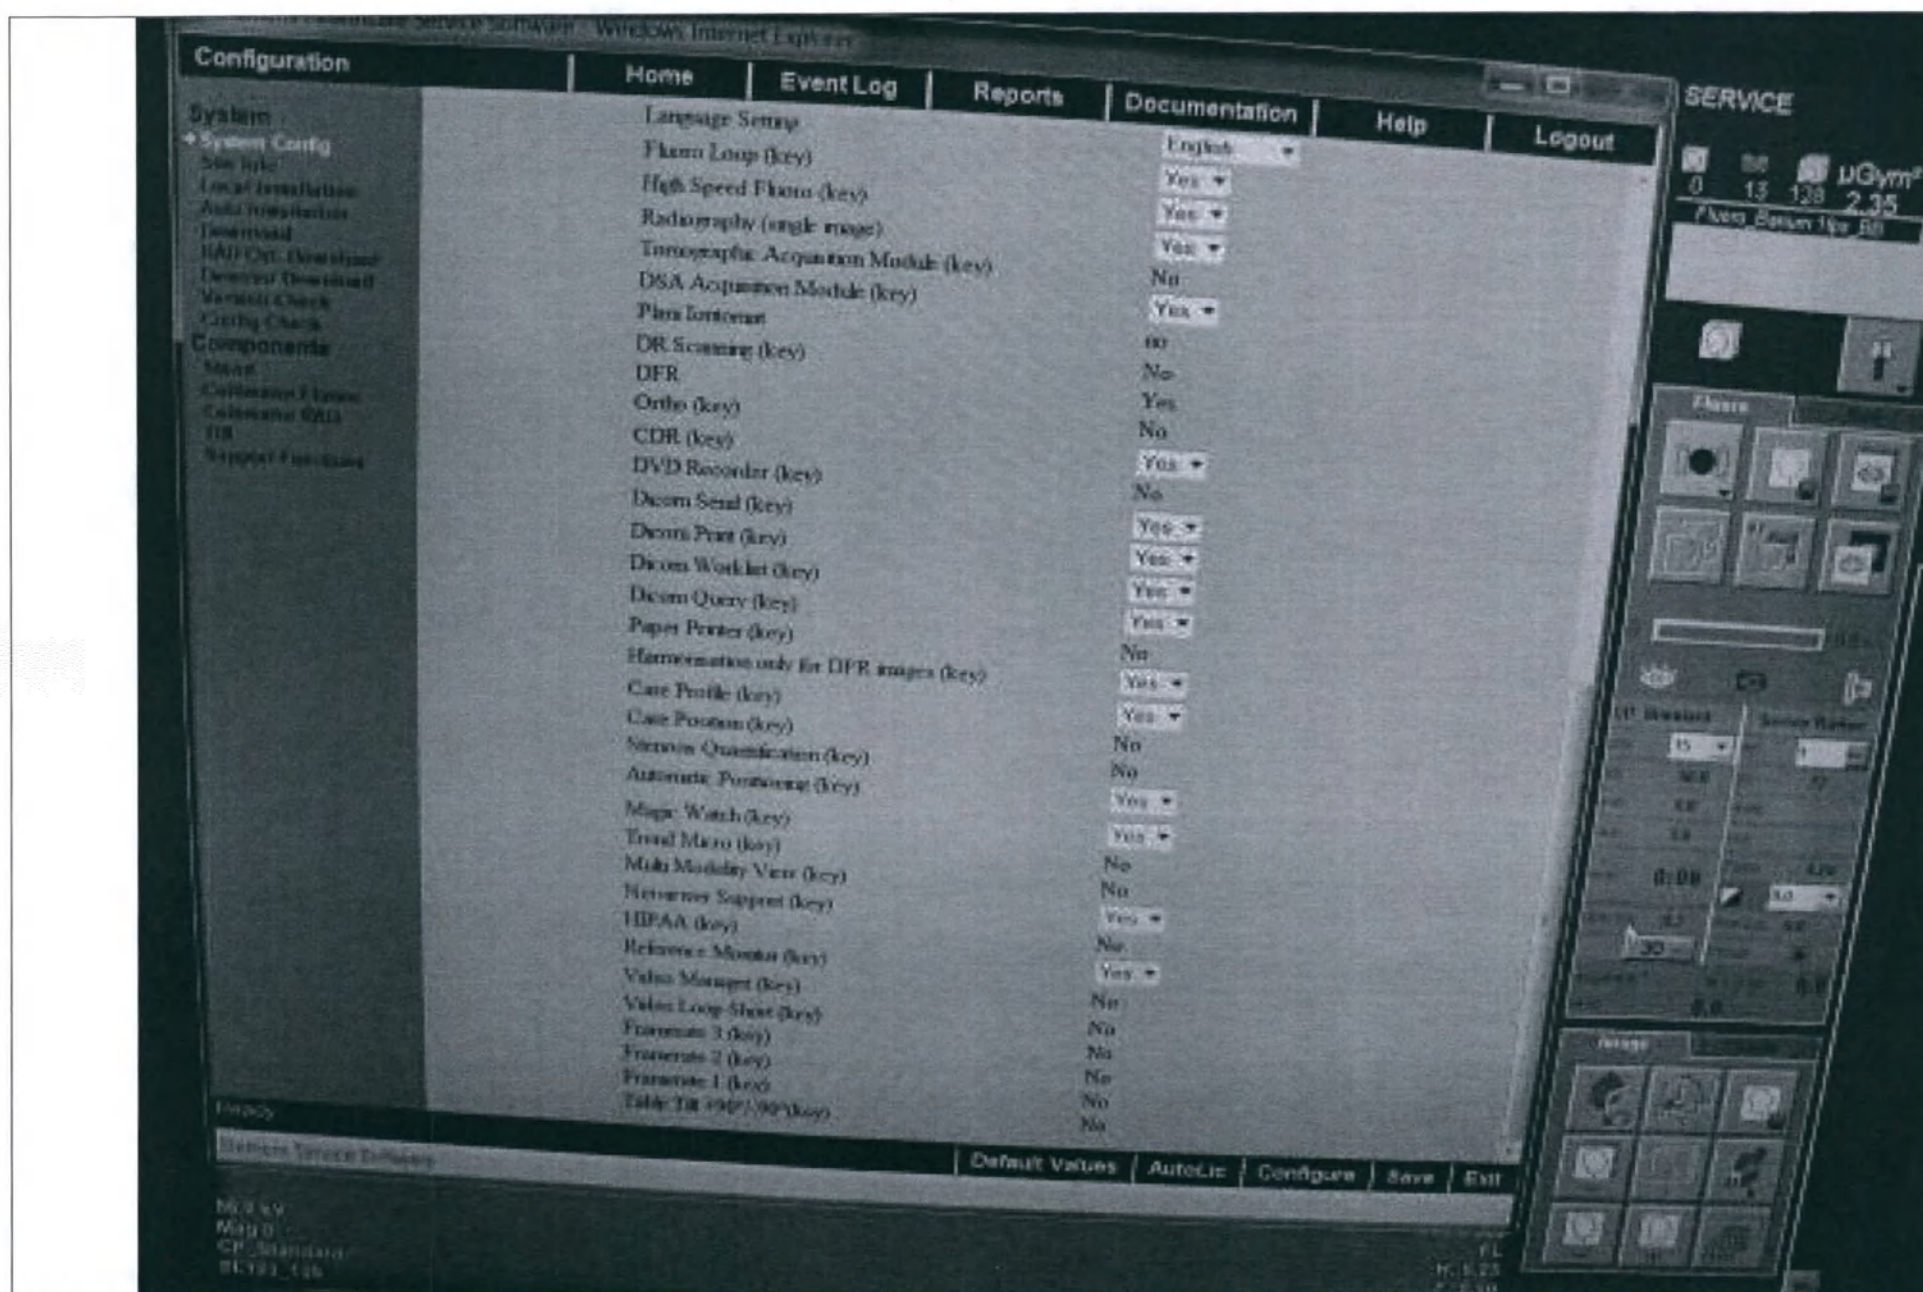


2. Лицензионный ключ для активации программного режима автоматического позиционирования

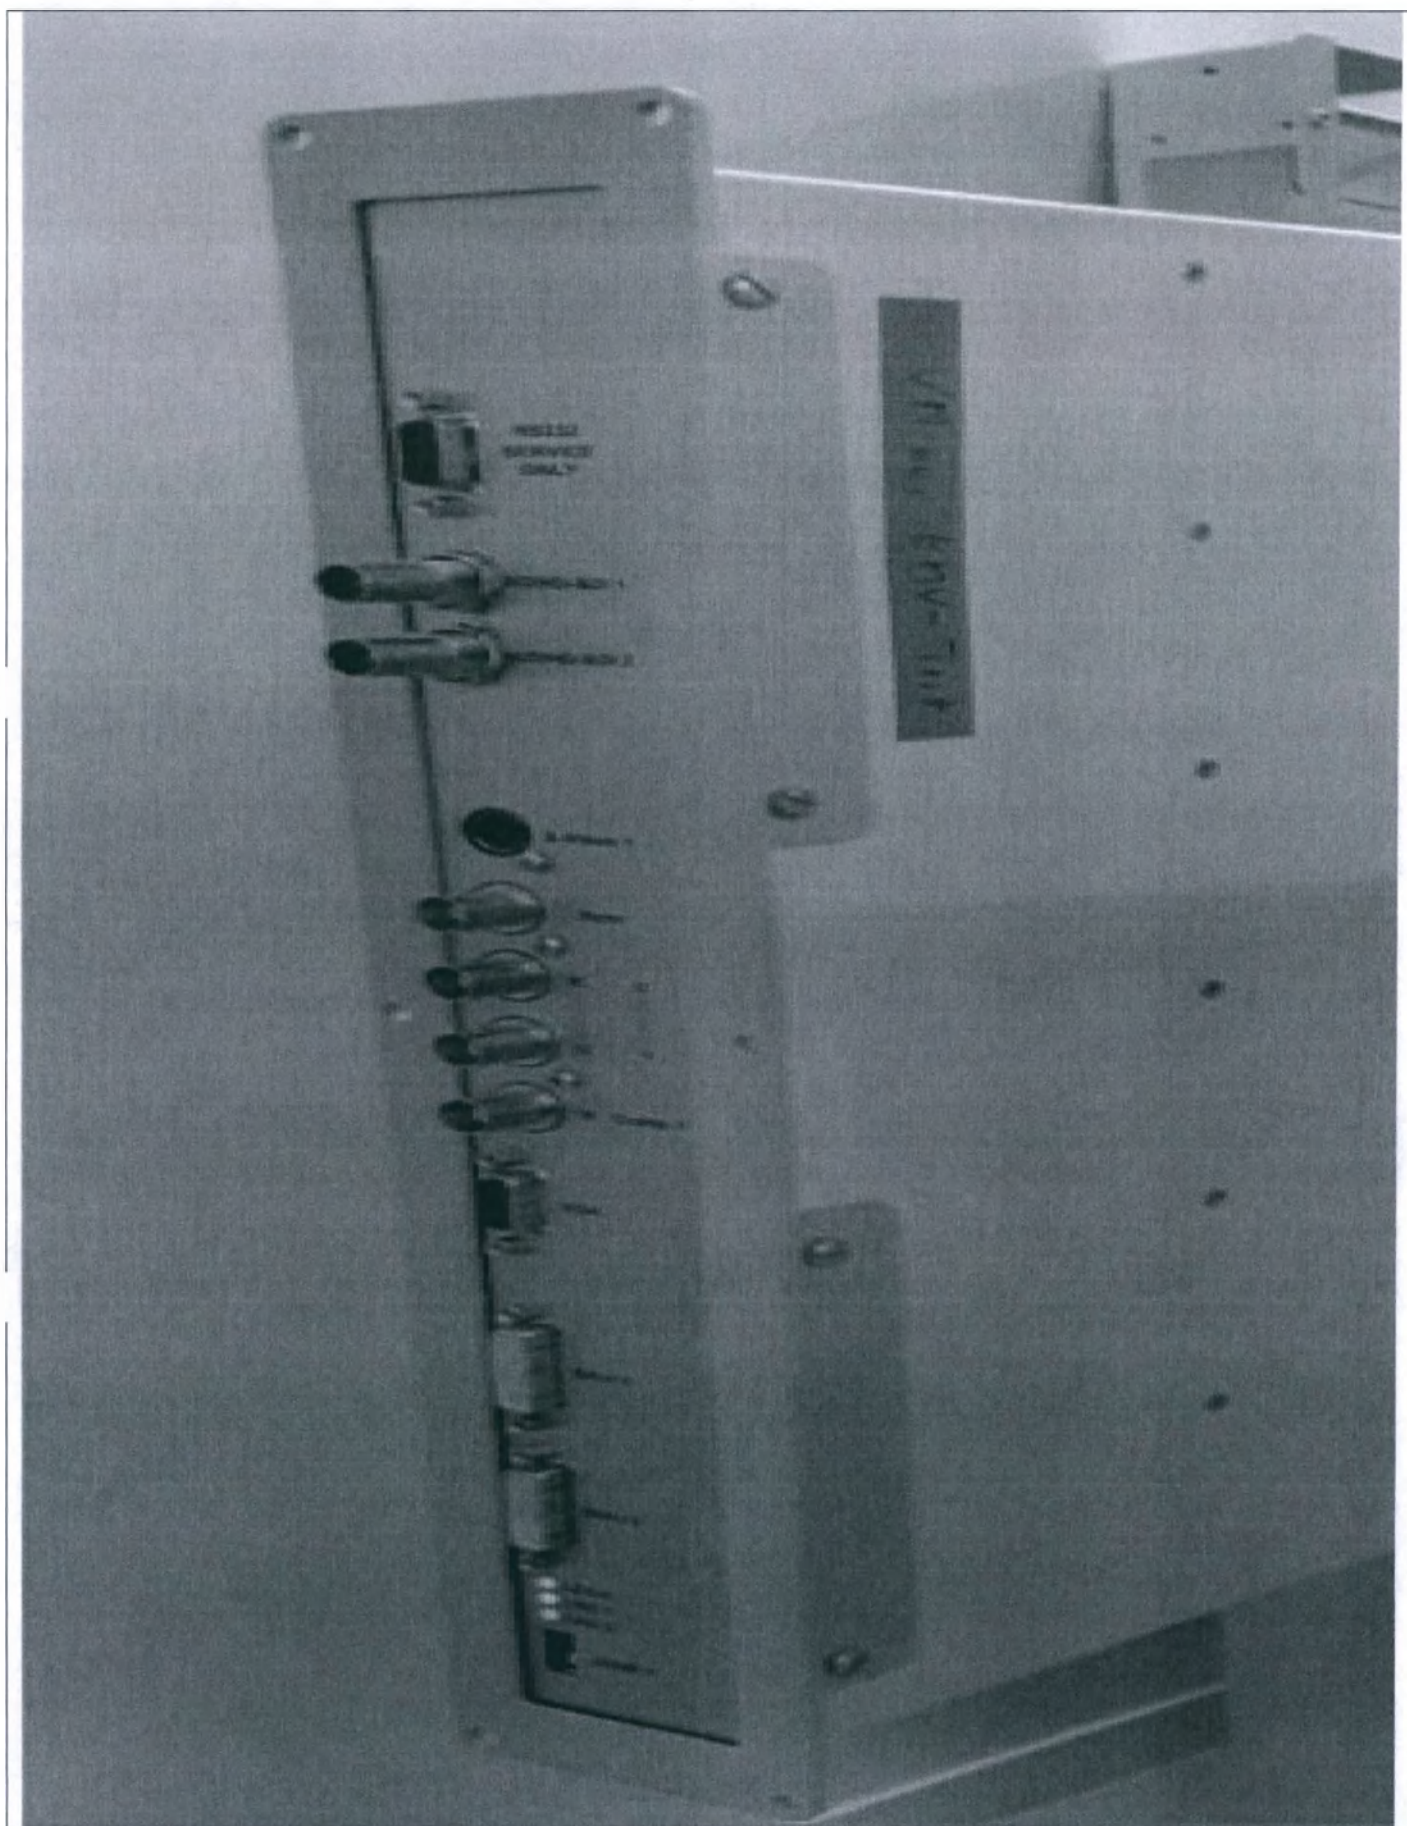


3. Интерфейс SmartView.

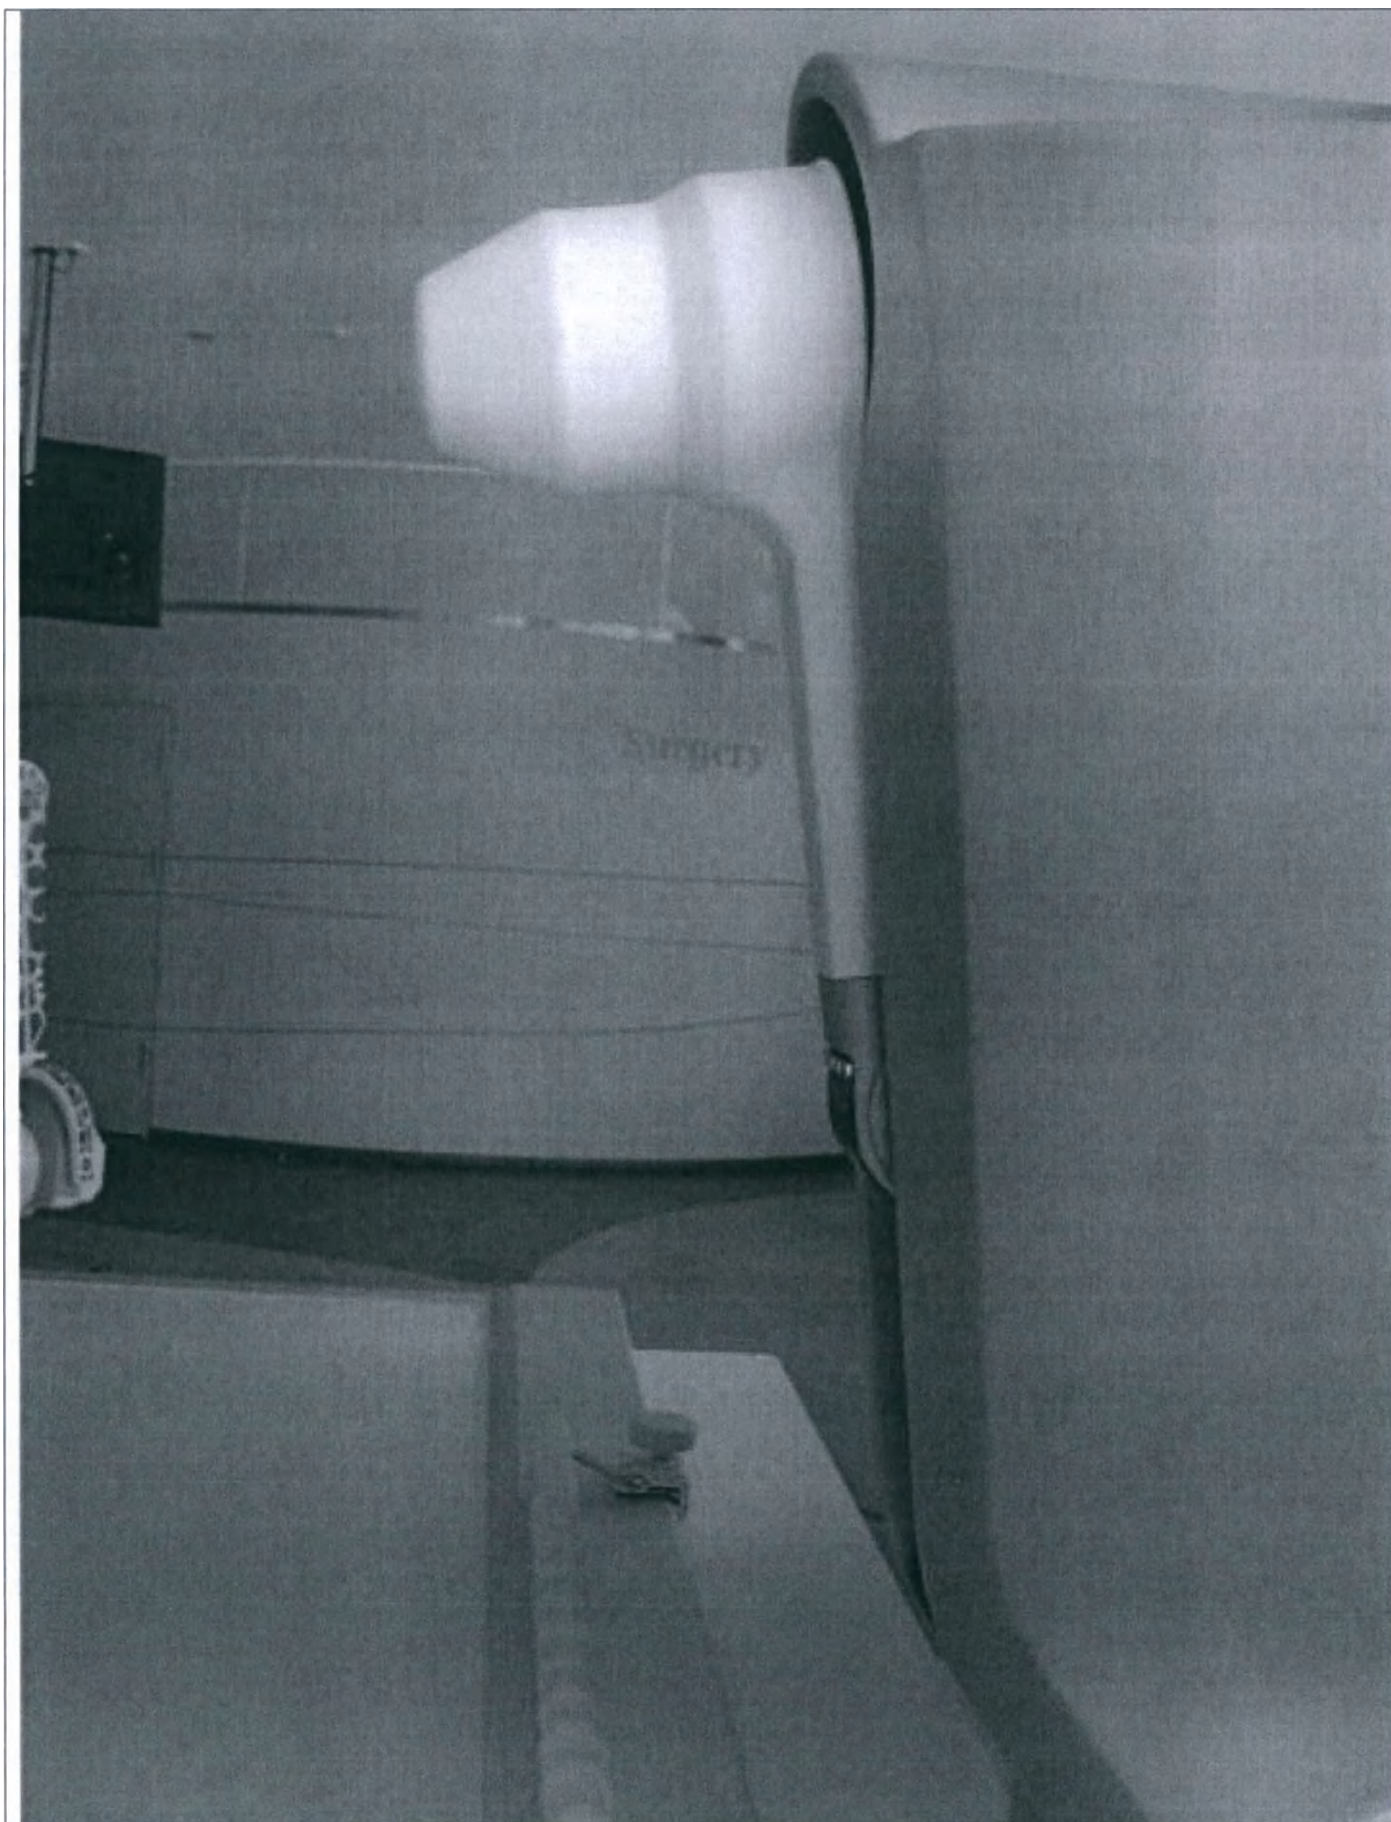


4. Устройство дистанционной компрессии.

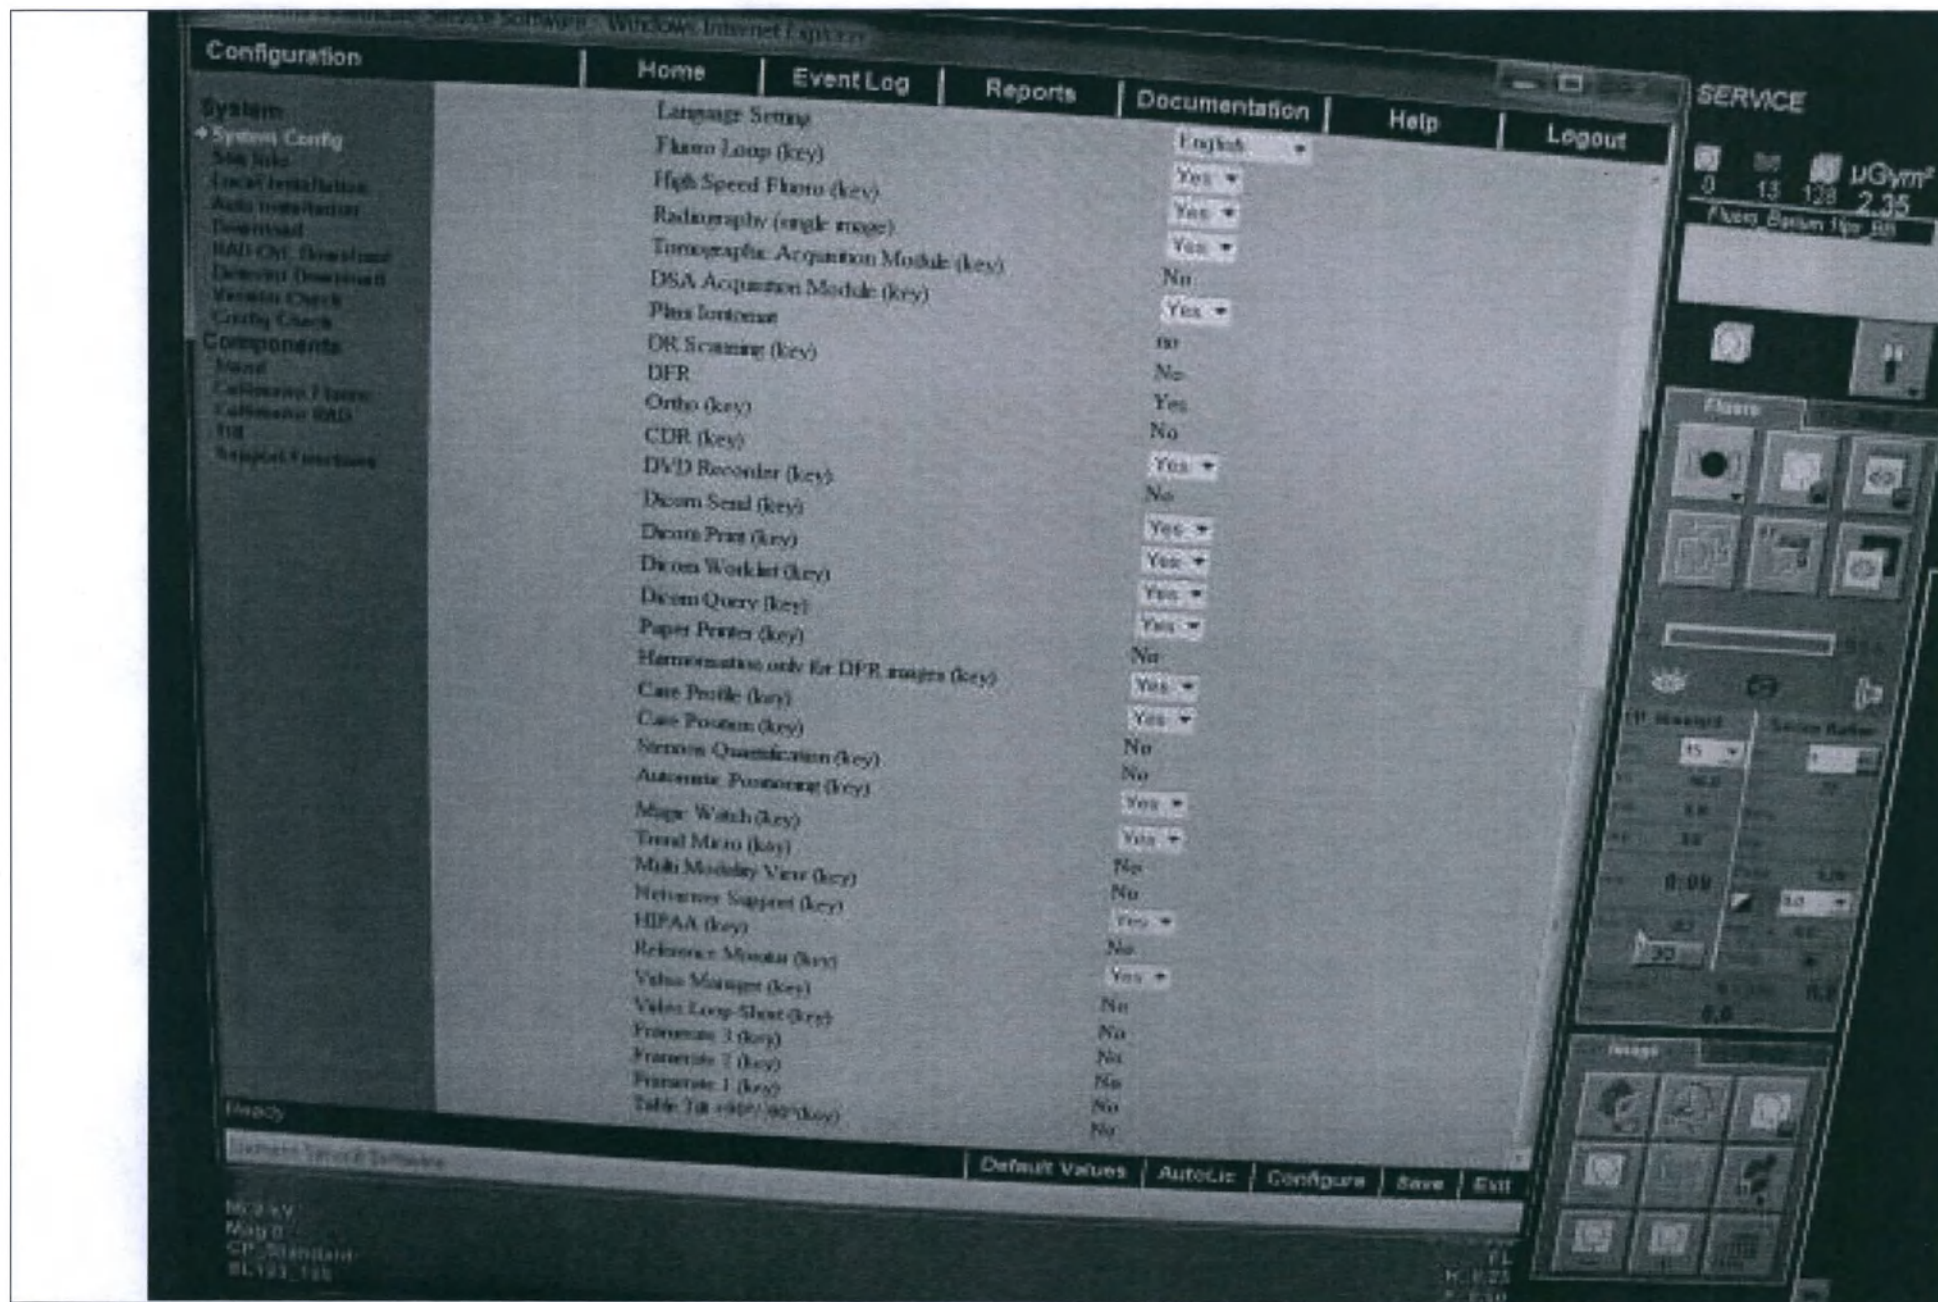


5. Лицензионный ключ для активации программного режима Томография.

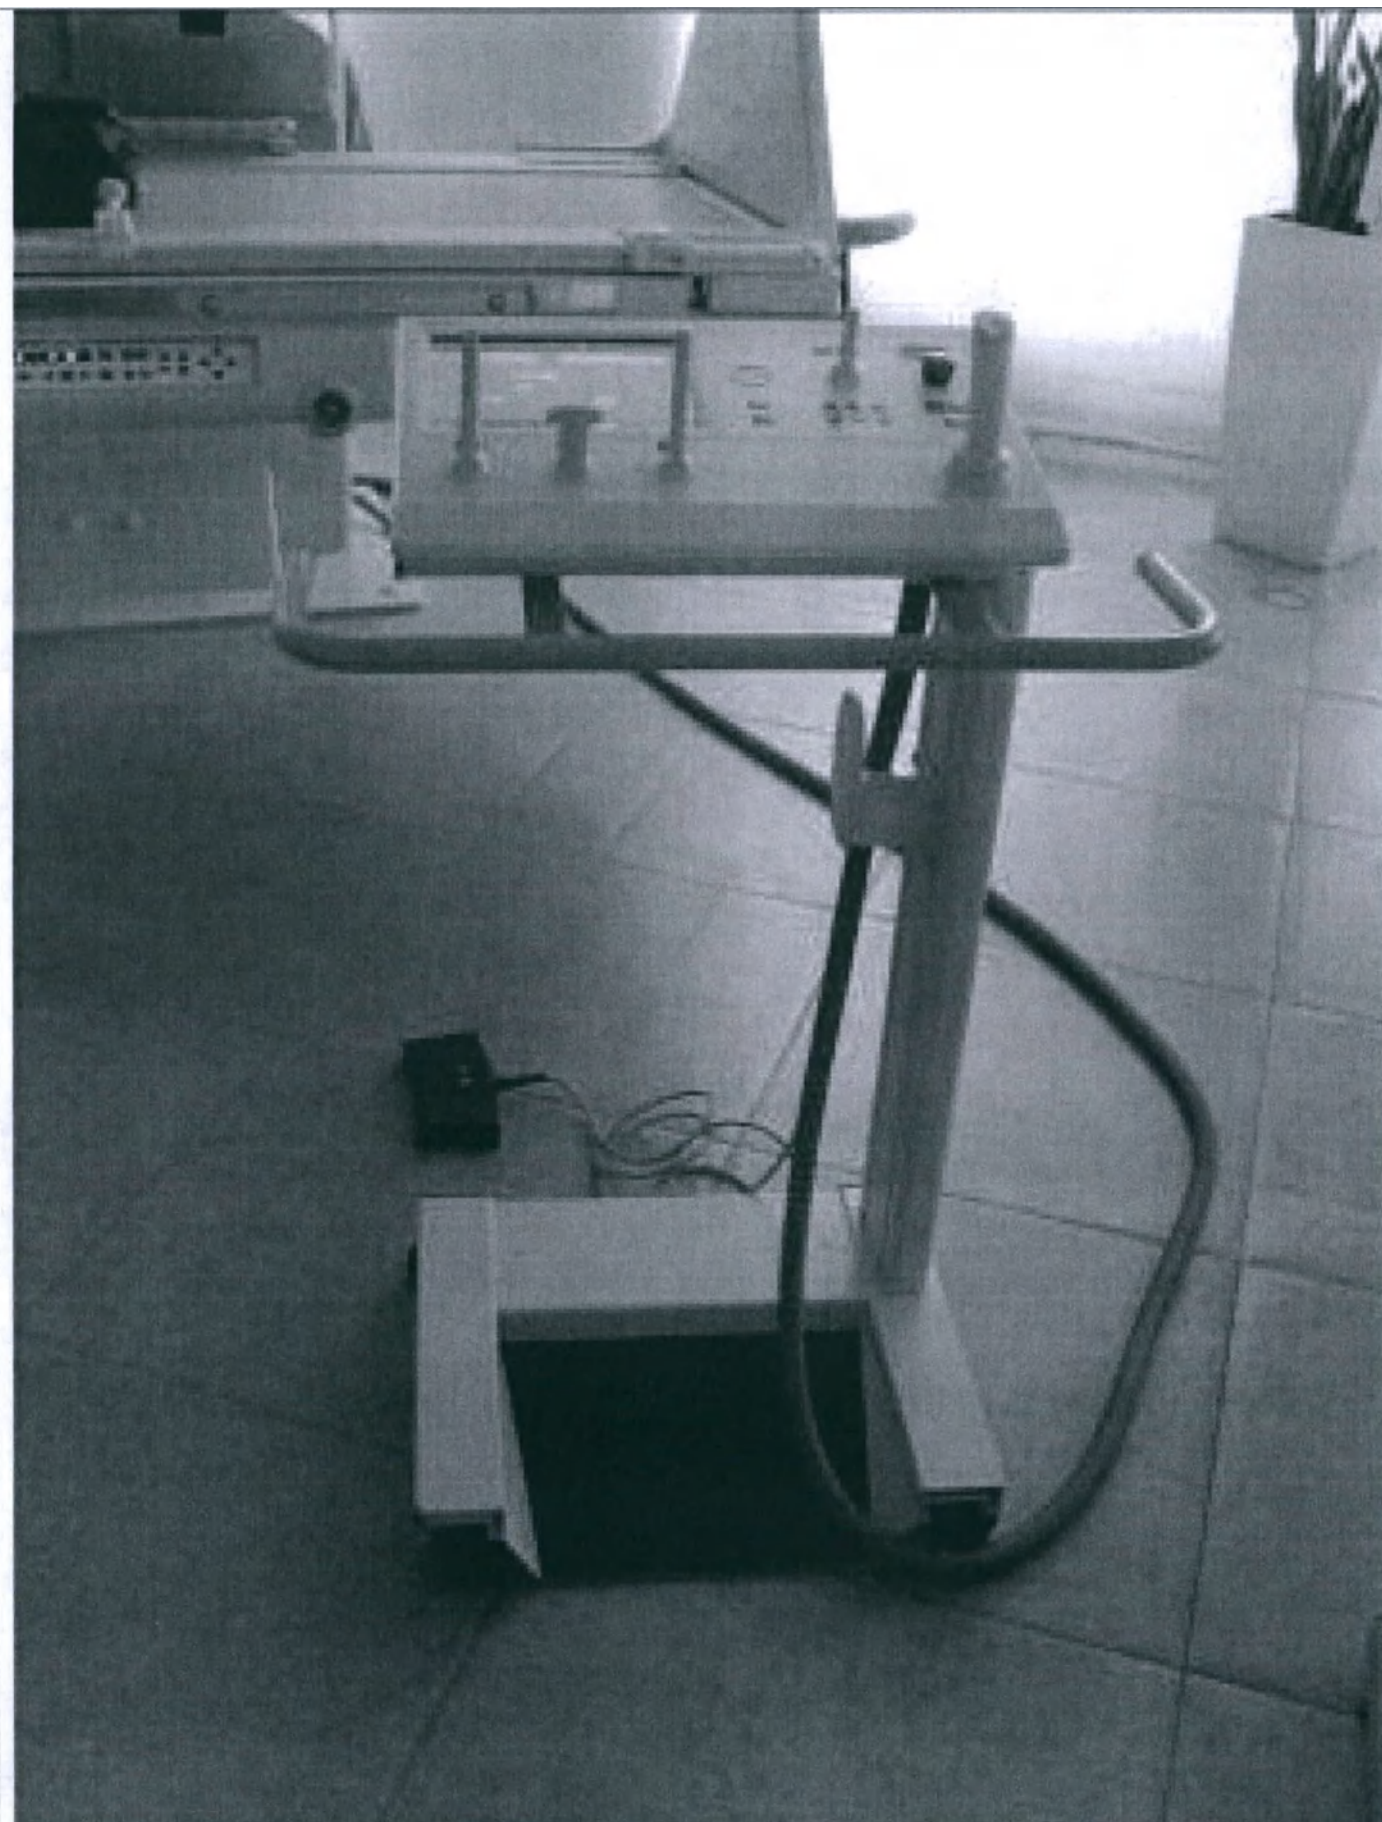


7. Консоль управления в процедурной на тележке.

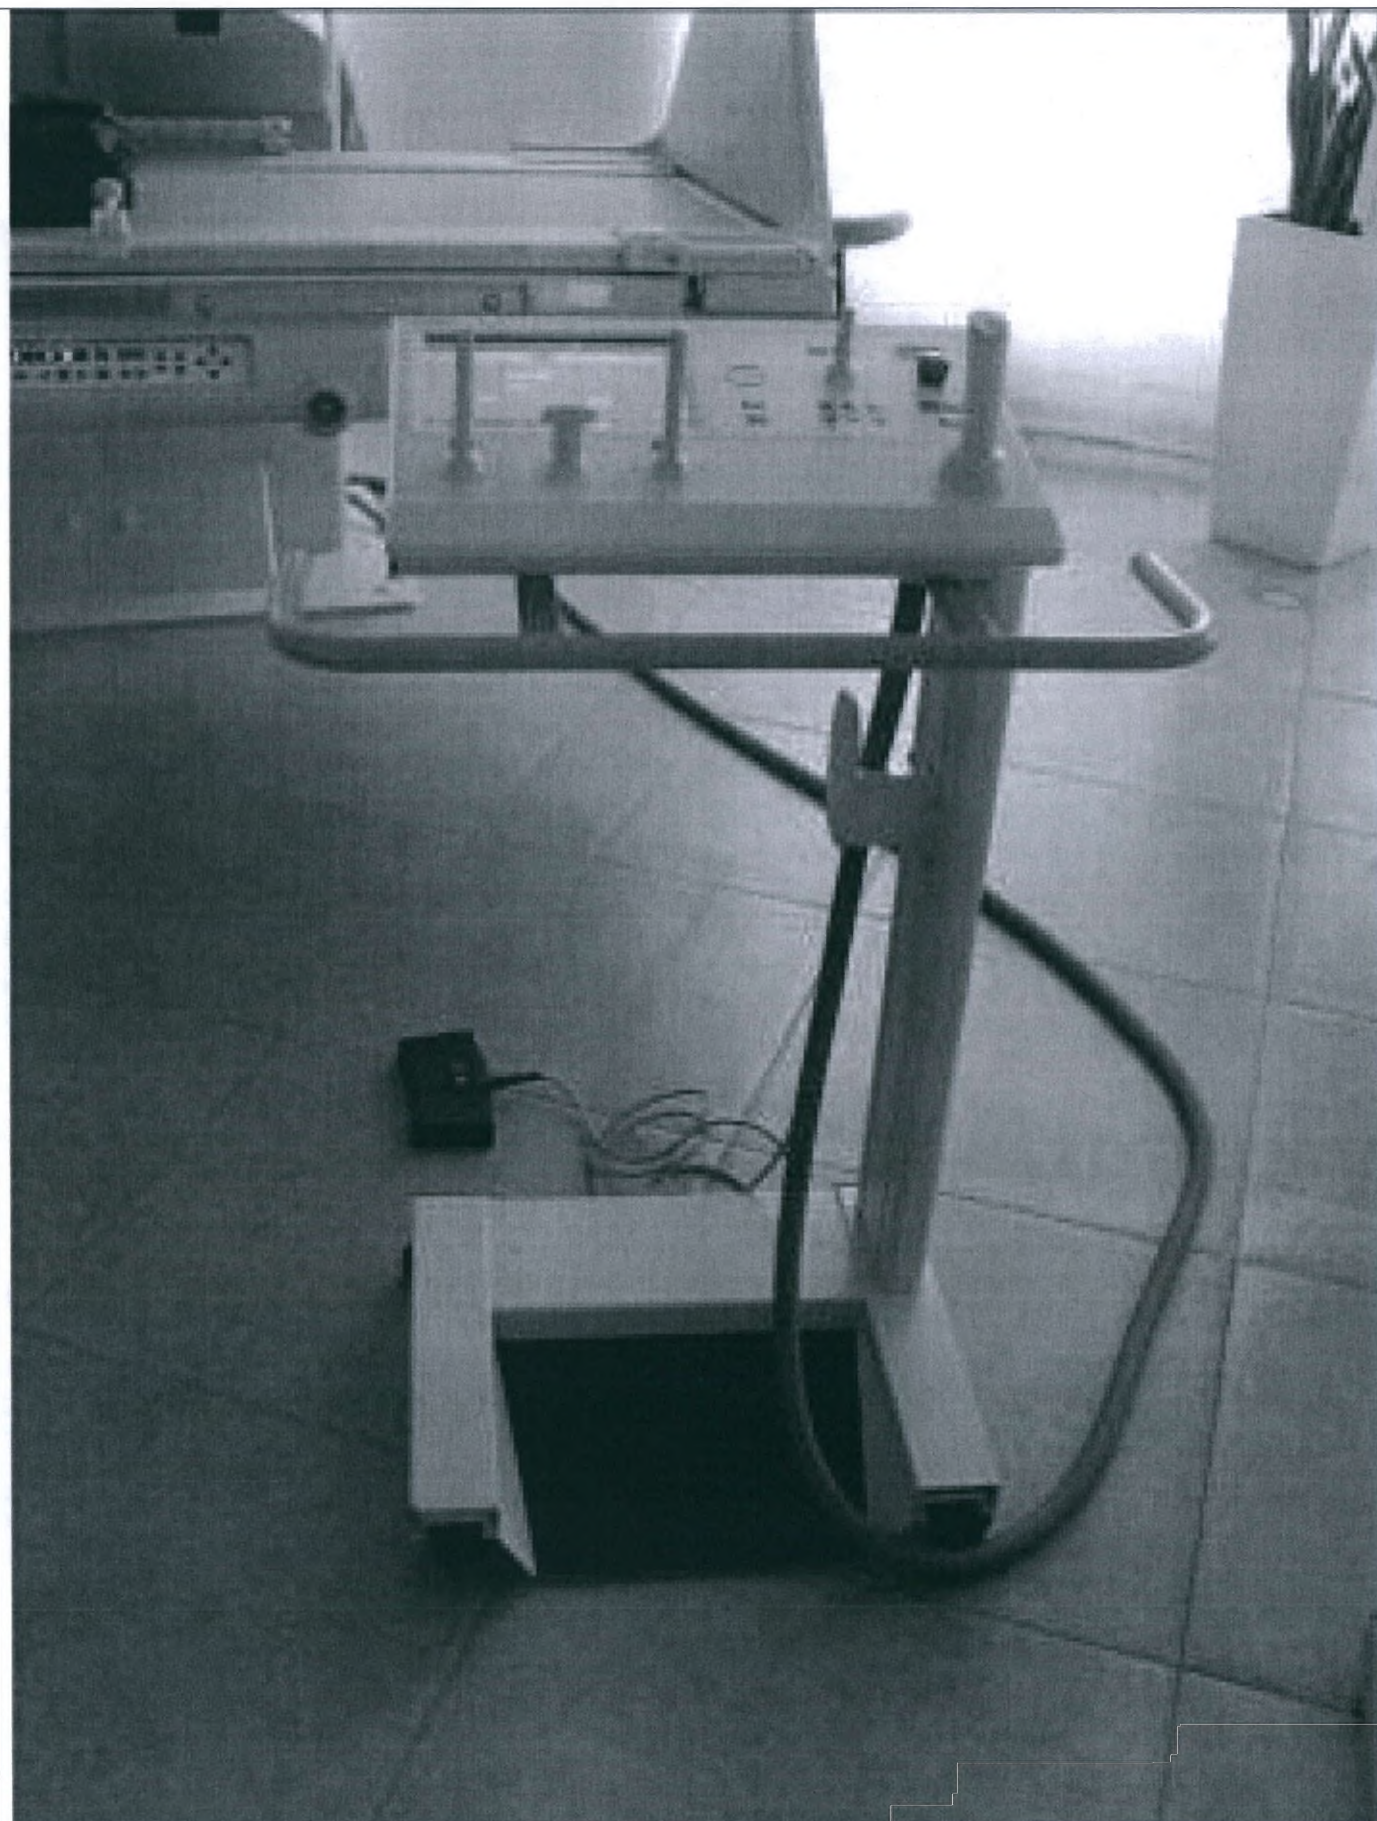


8. Консоль управления в процедурной на тележке (для коллиматора с полупрозрачными фильтрами)

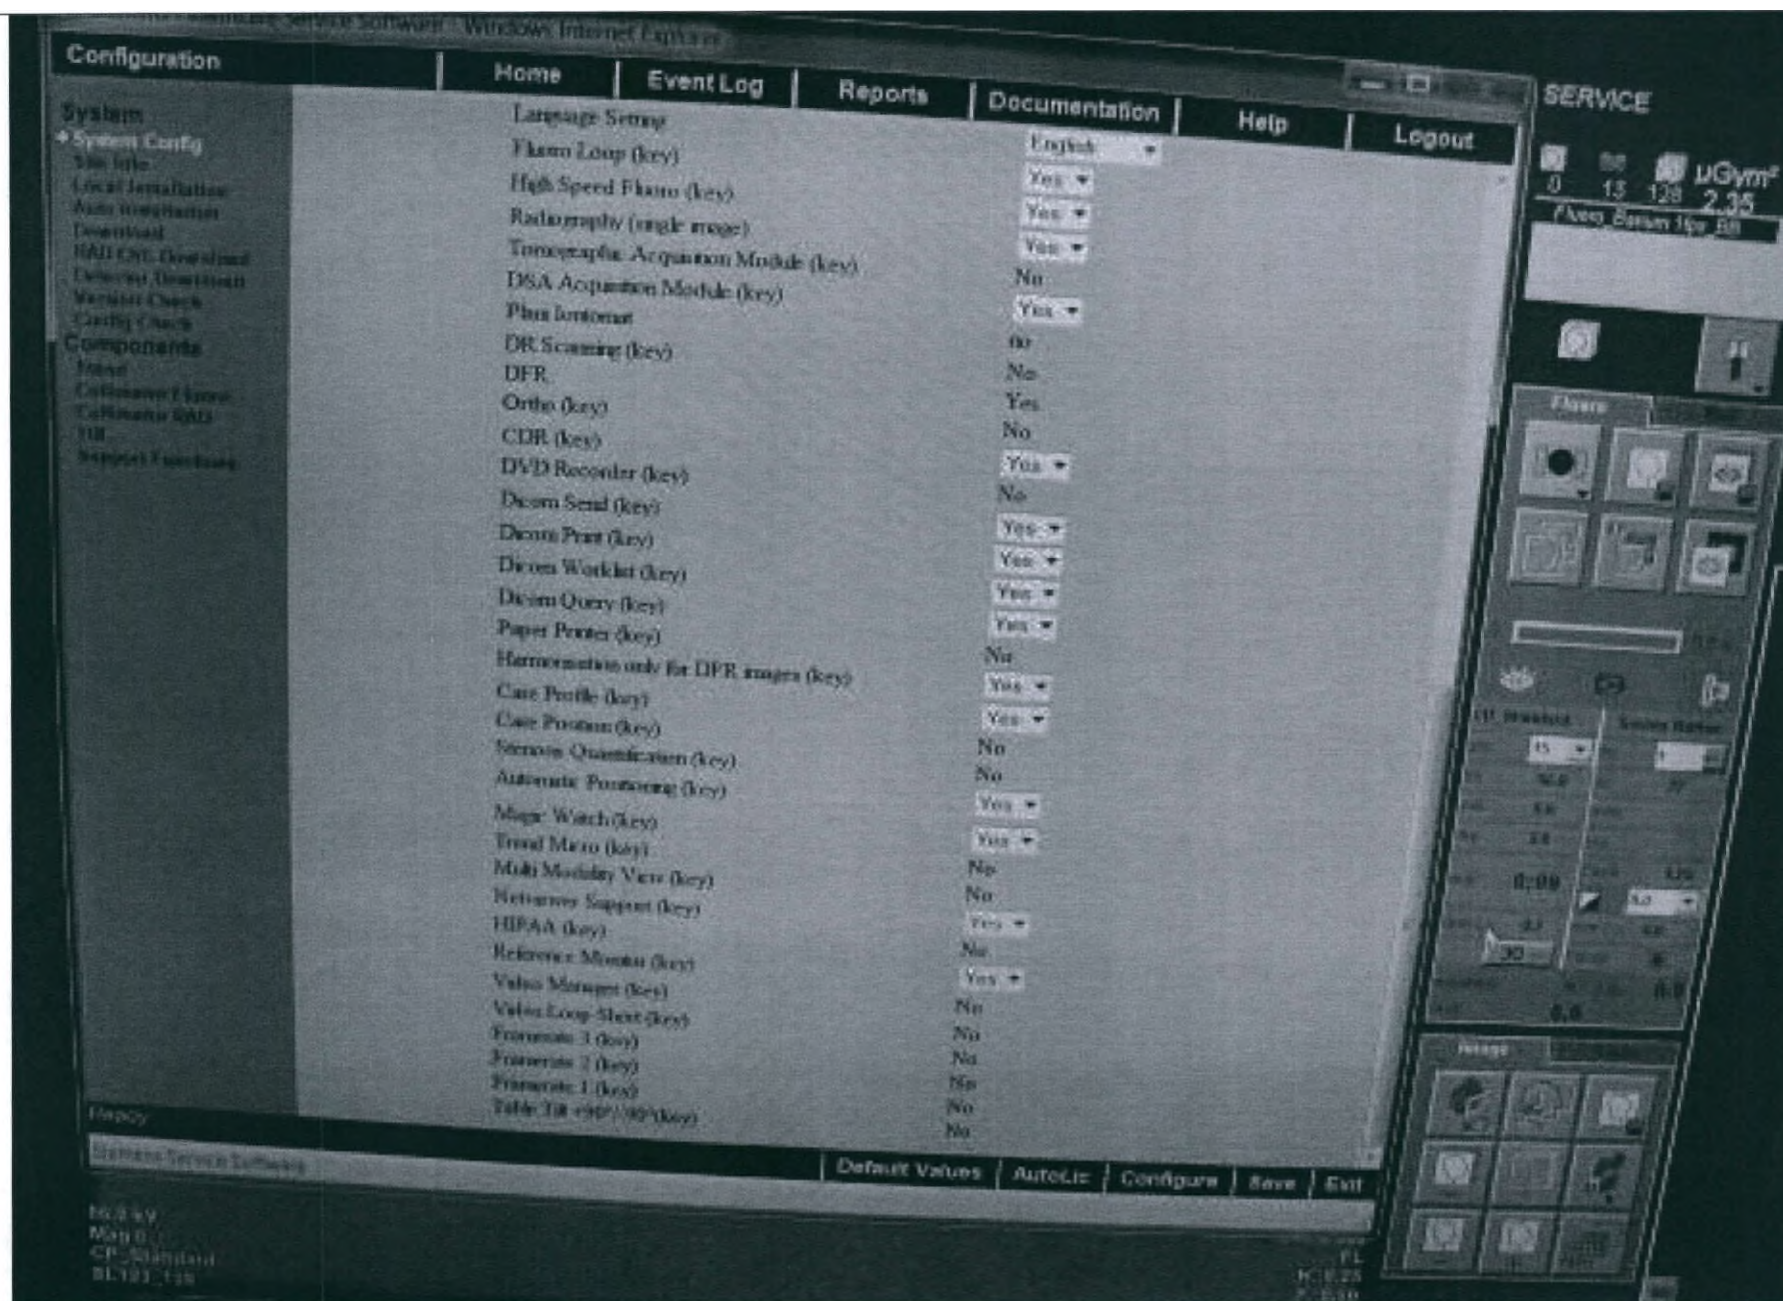


10. Лицензионный ключ для активации программного режима Query and Retrieve.

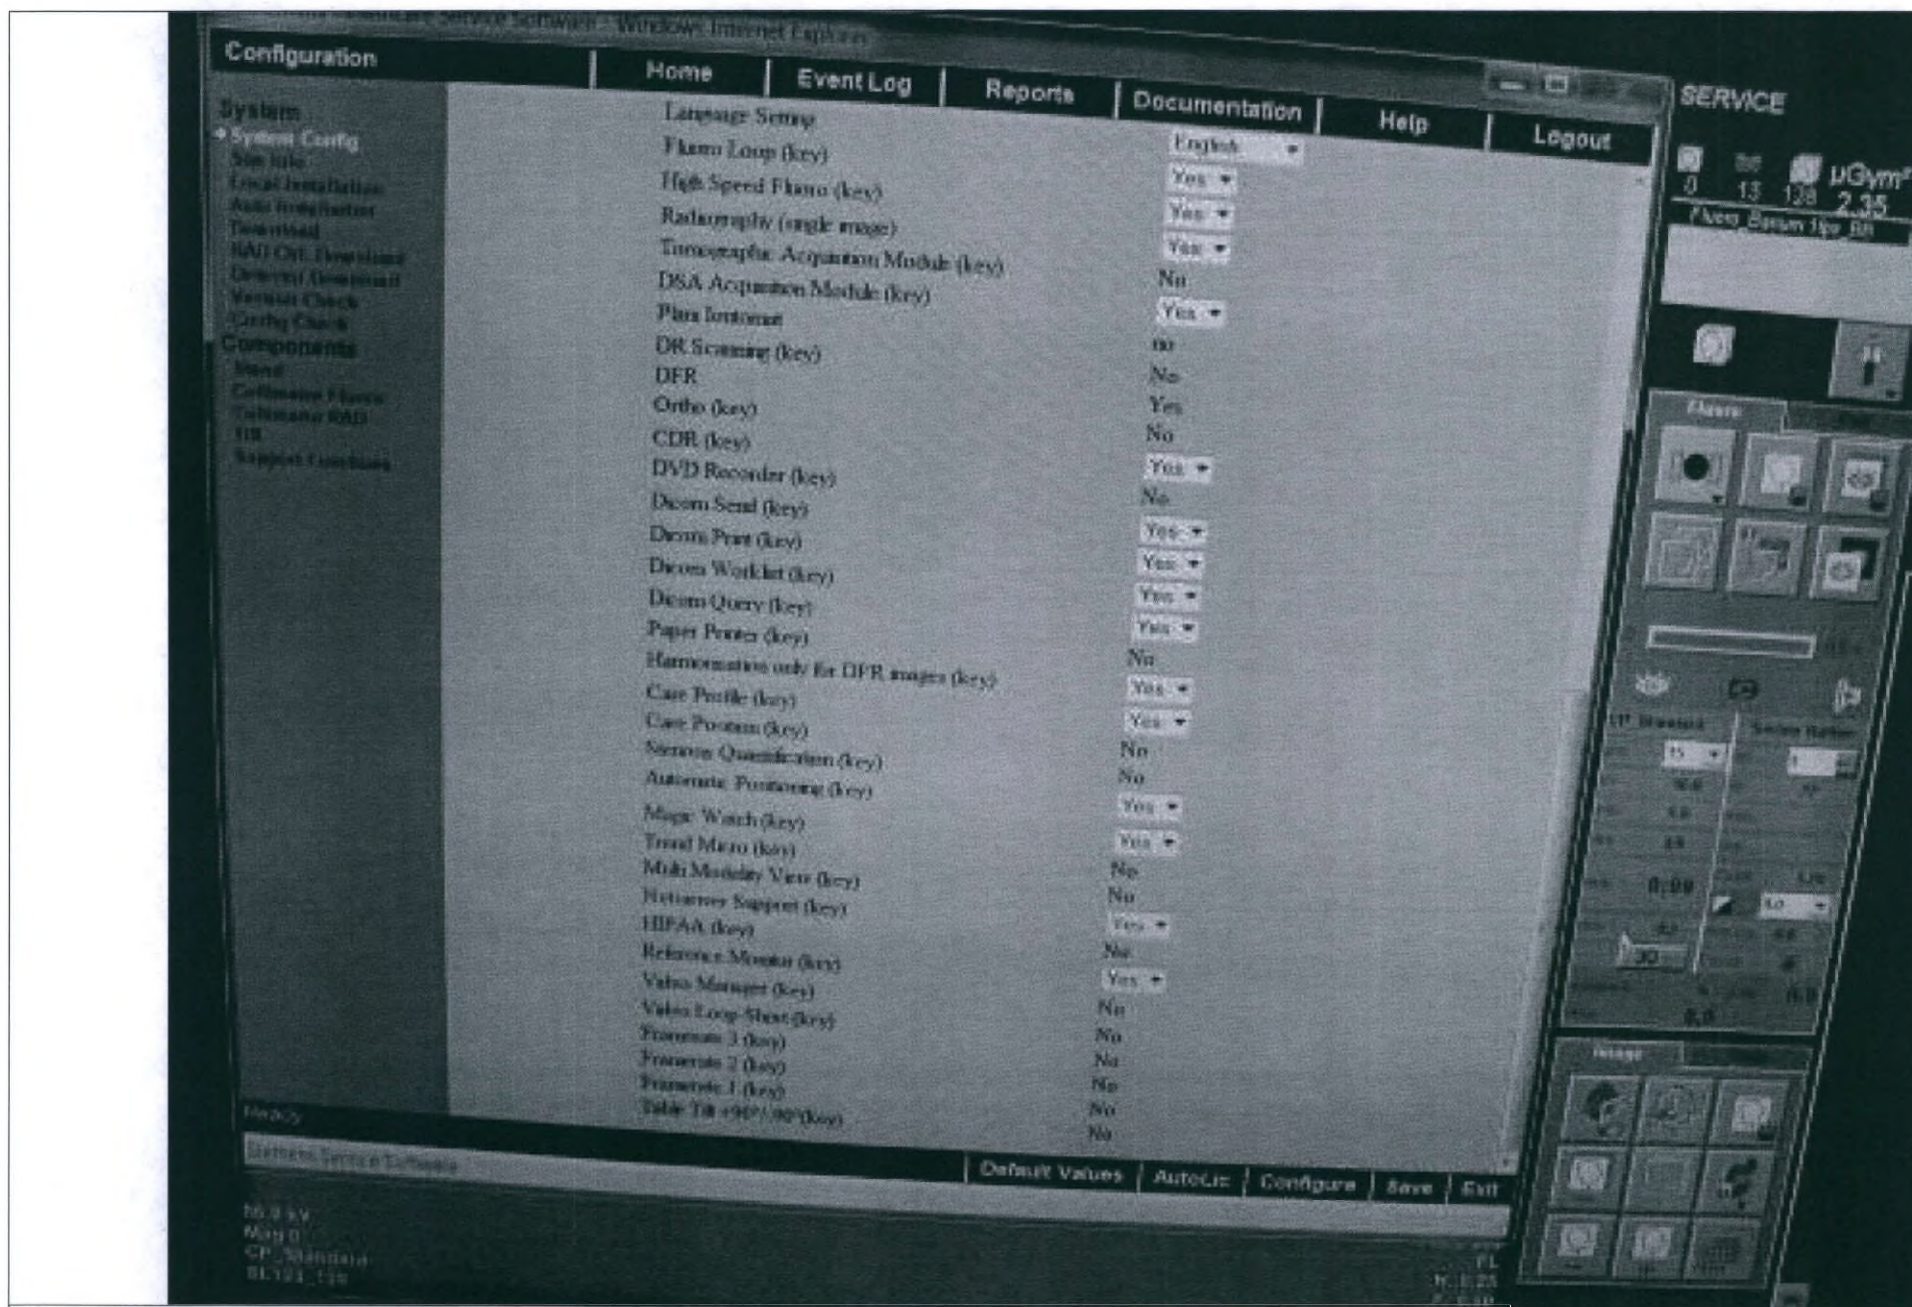


11. Лицензионный ключ для активации программного режима установки коллиматора по последнему кадру CAREPROFILE.

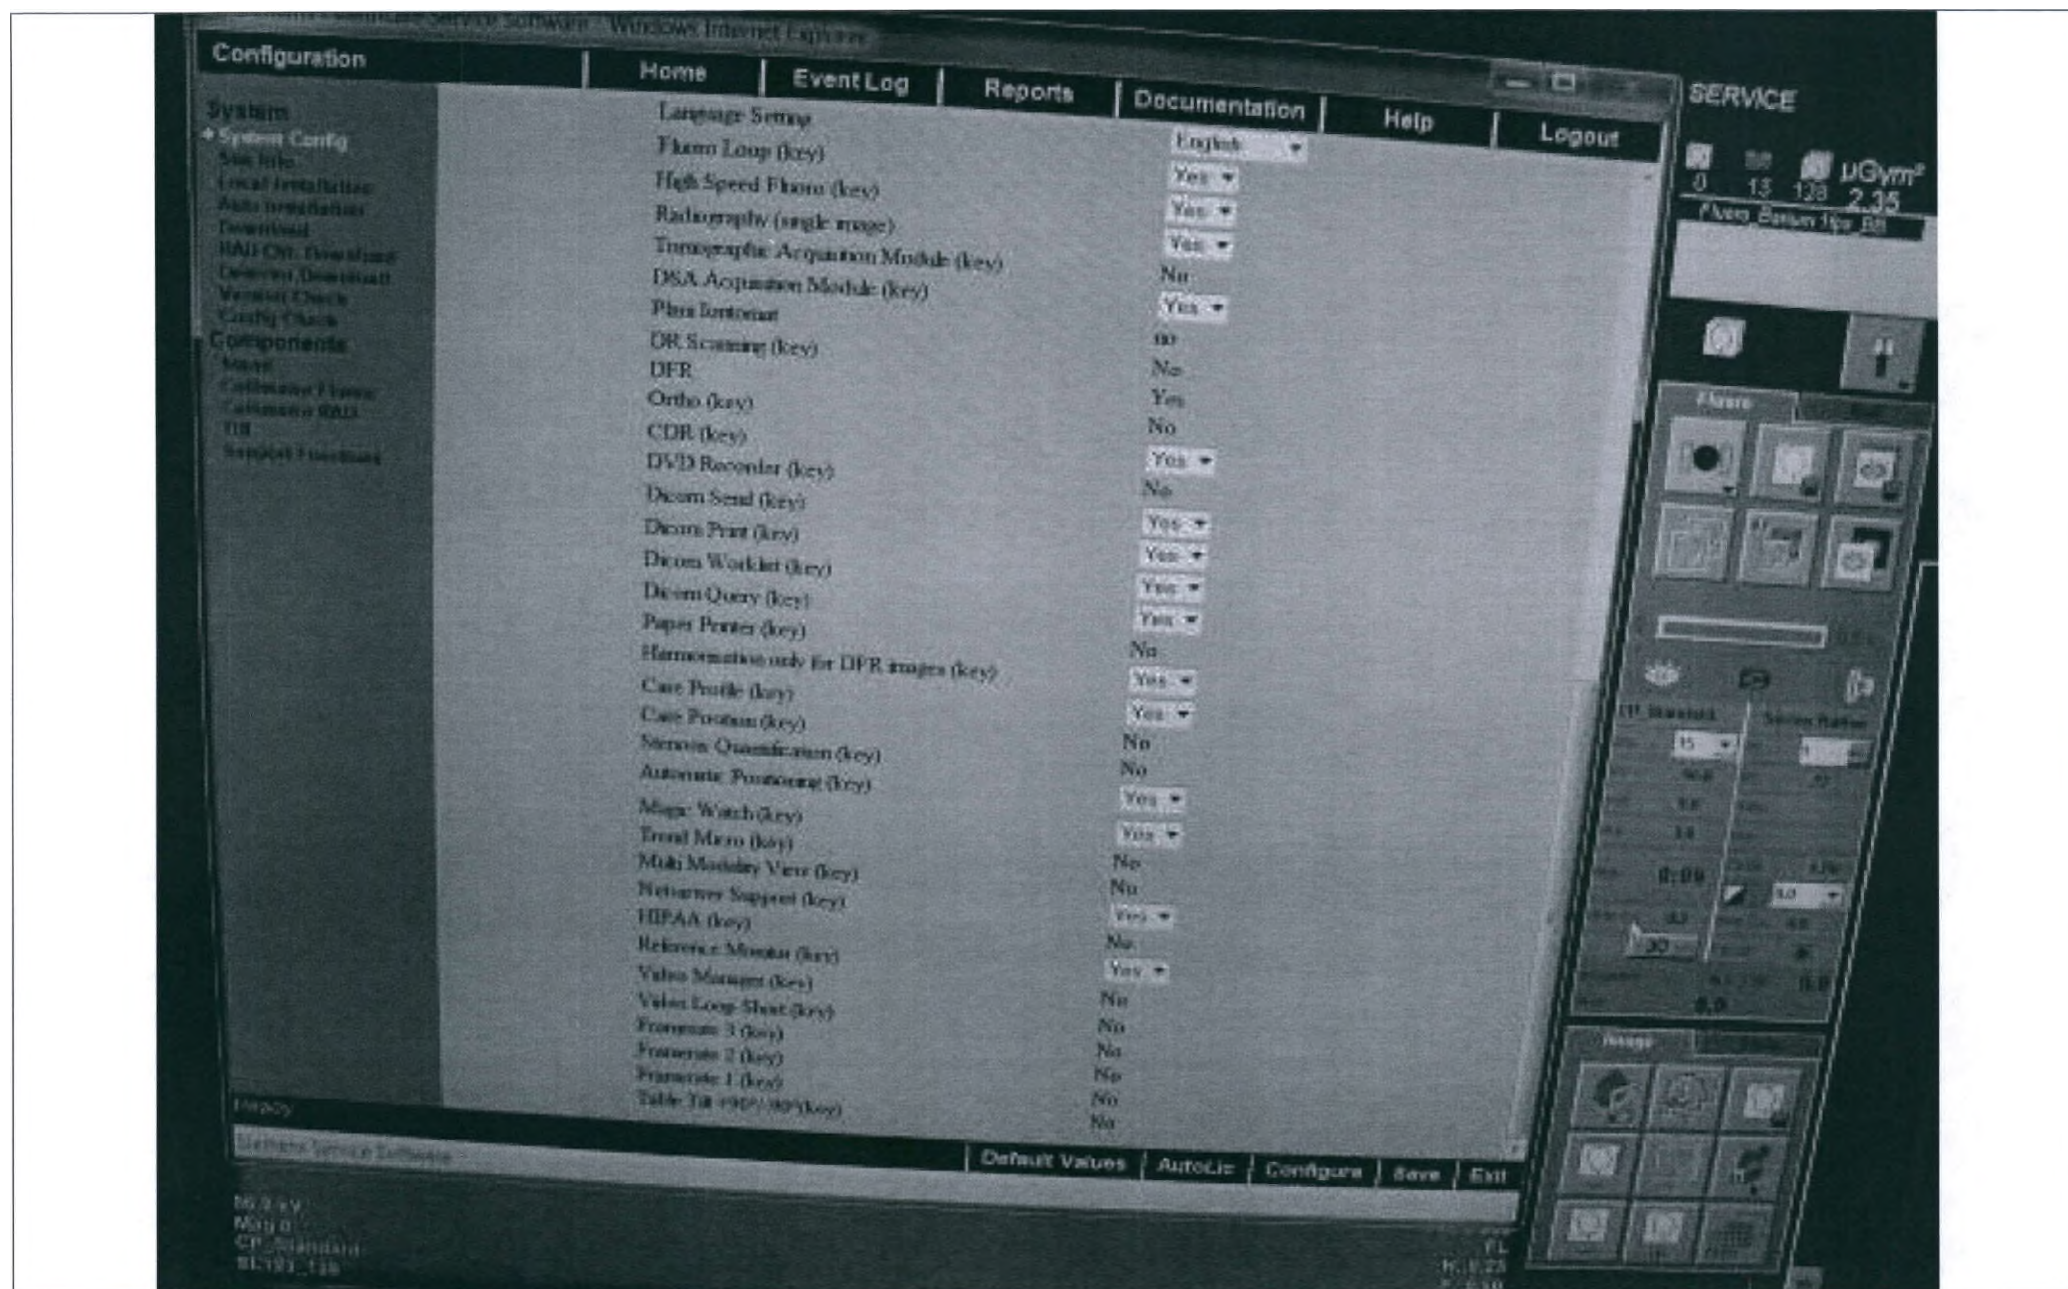


12. Лицензионный ключ для активации программного режима установки центрального луча по последнему кадру CAREPOSITION.

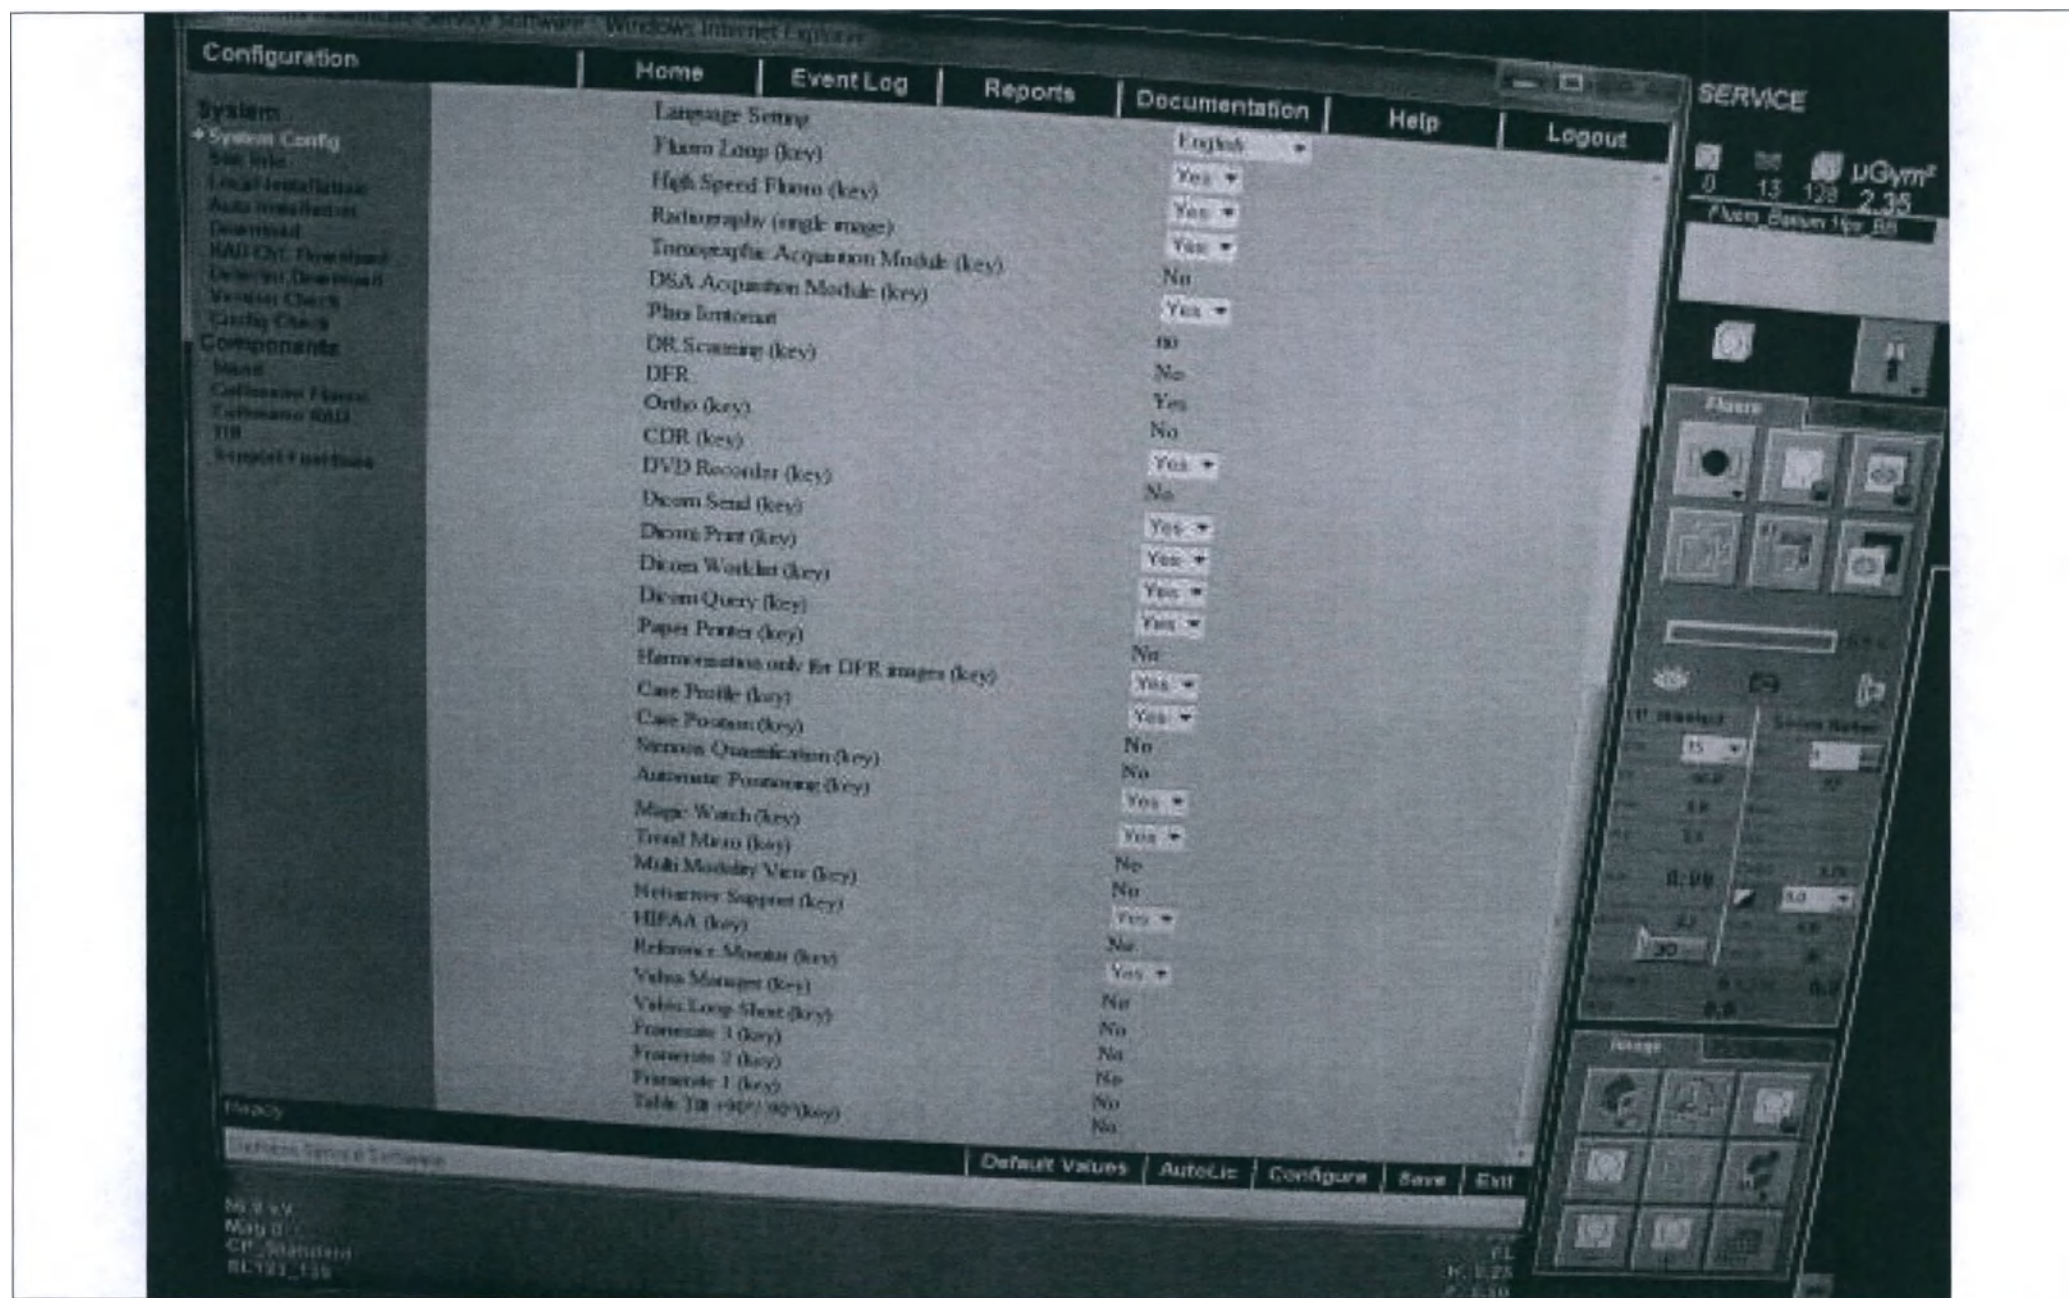


13. Лицензионный ключ для активации программного режима для флюороцикла FluoroLoop.

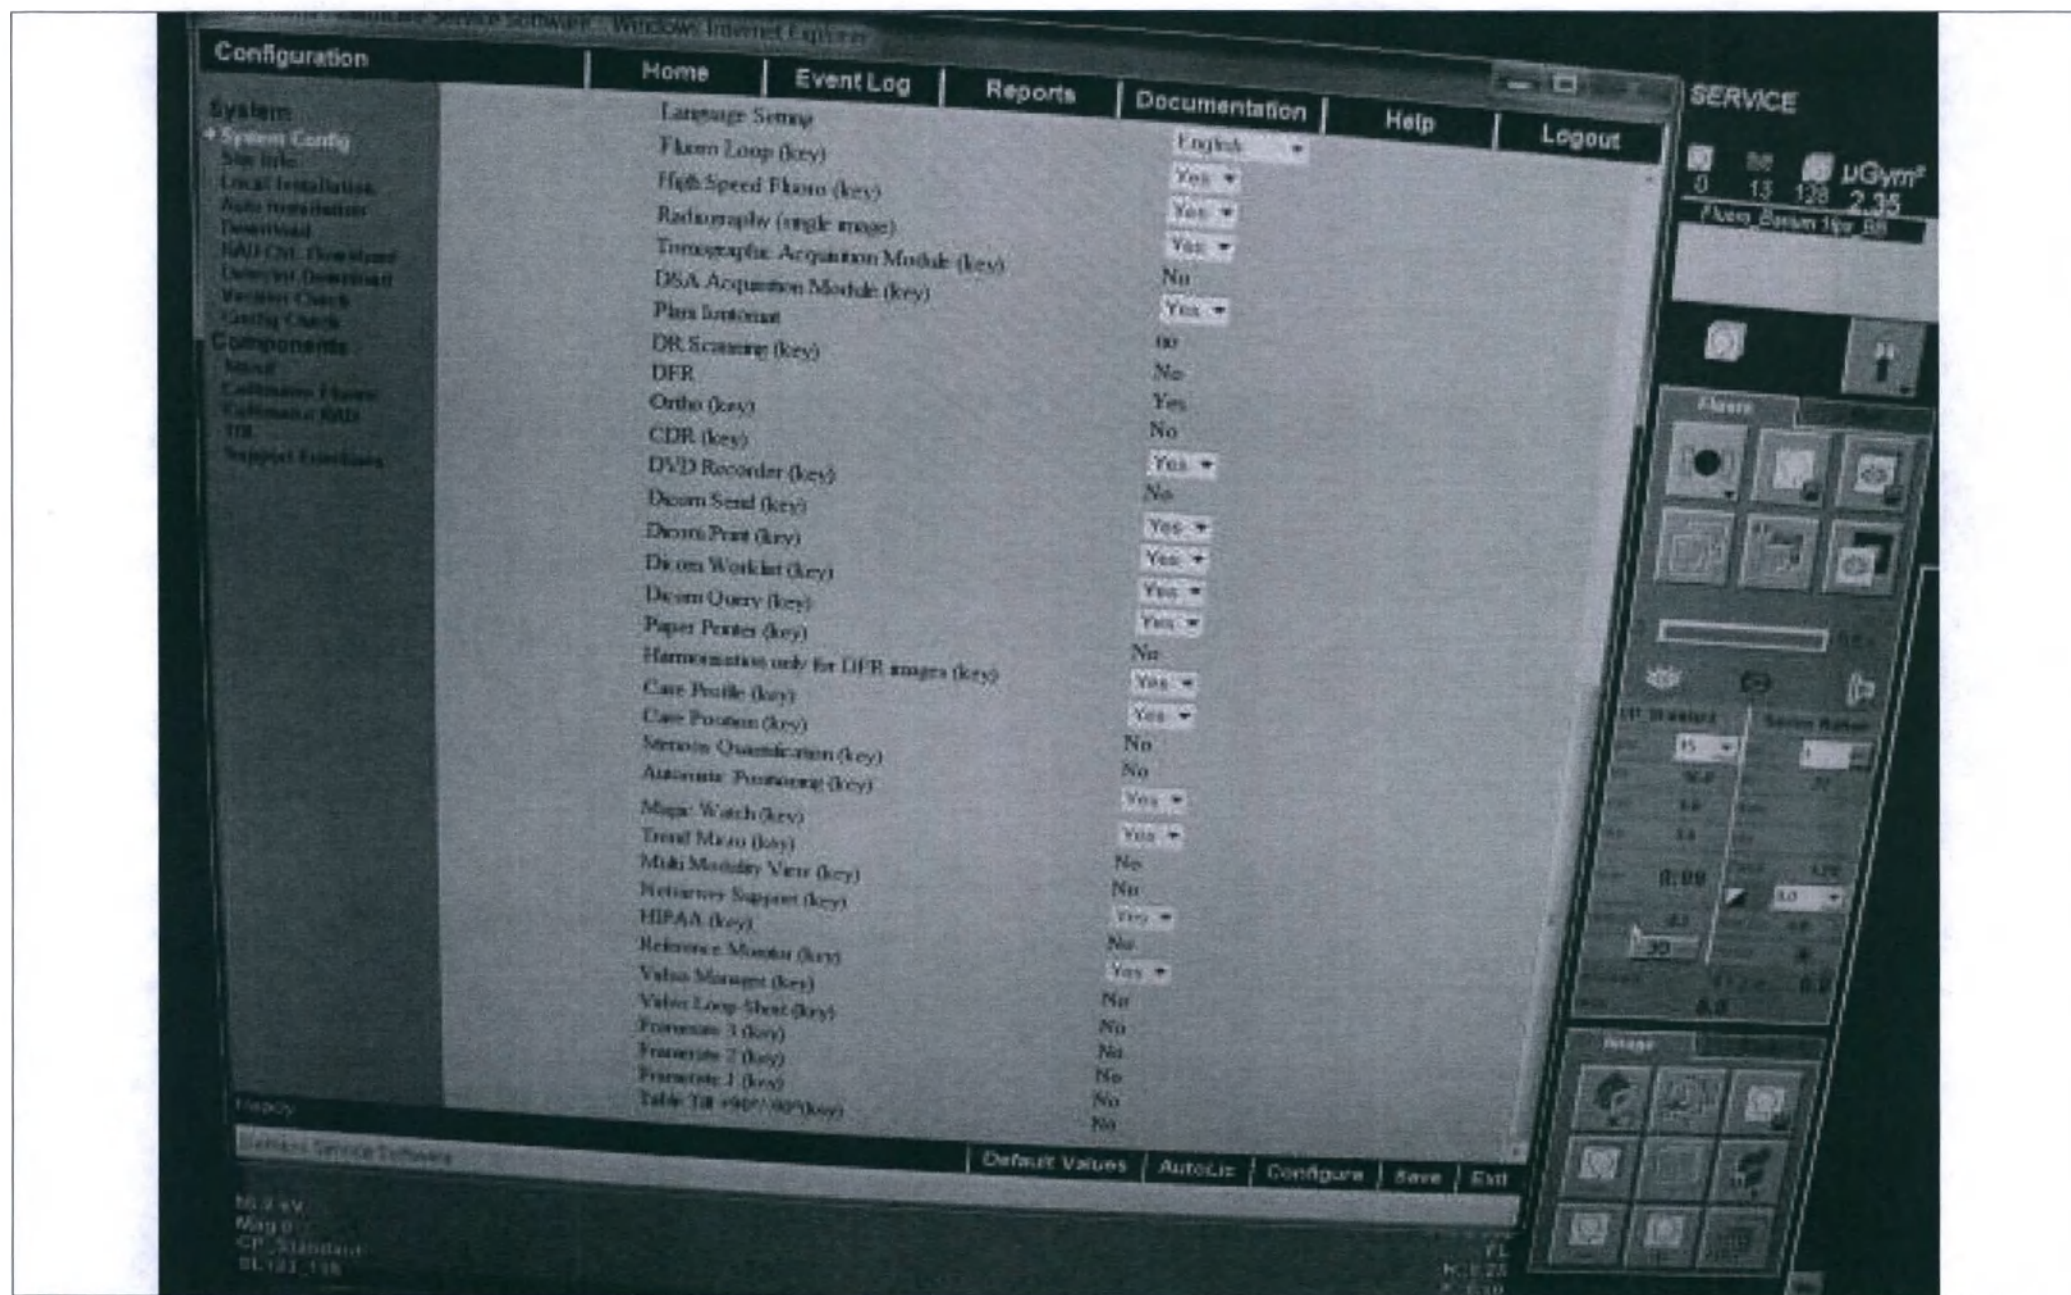


15. Лицензионный ключ для активации программного режима HIPAA.

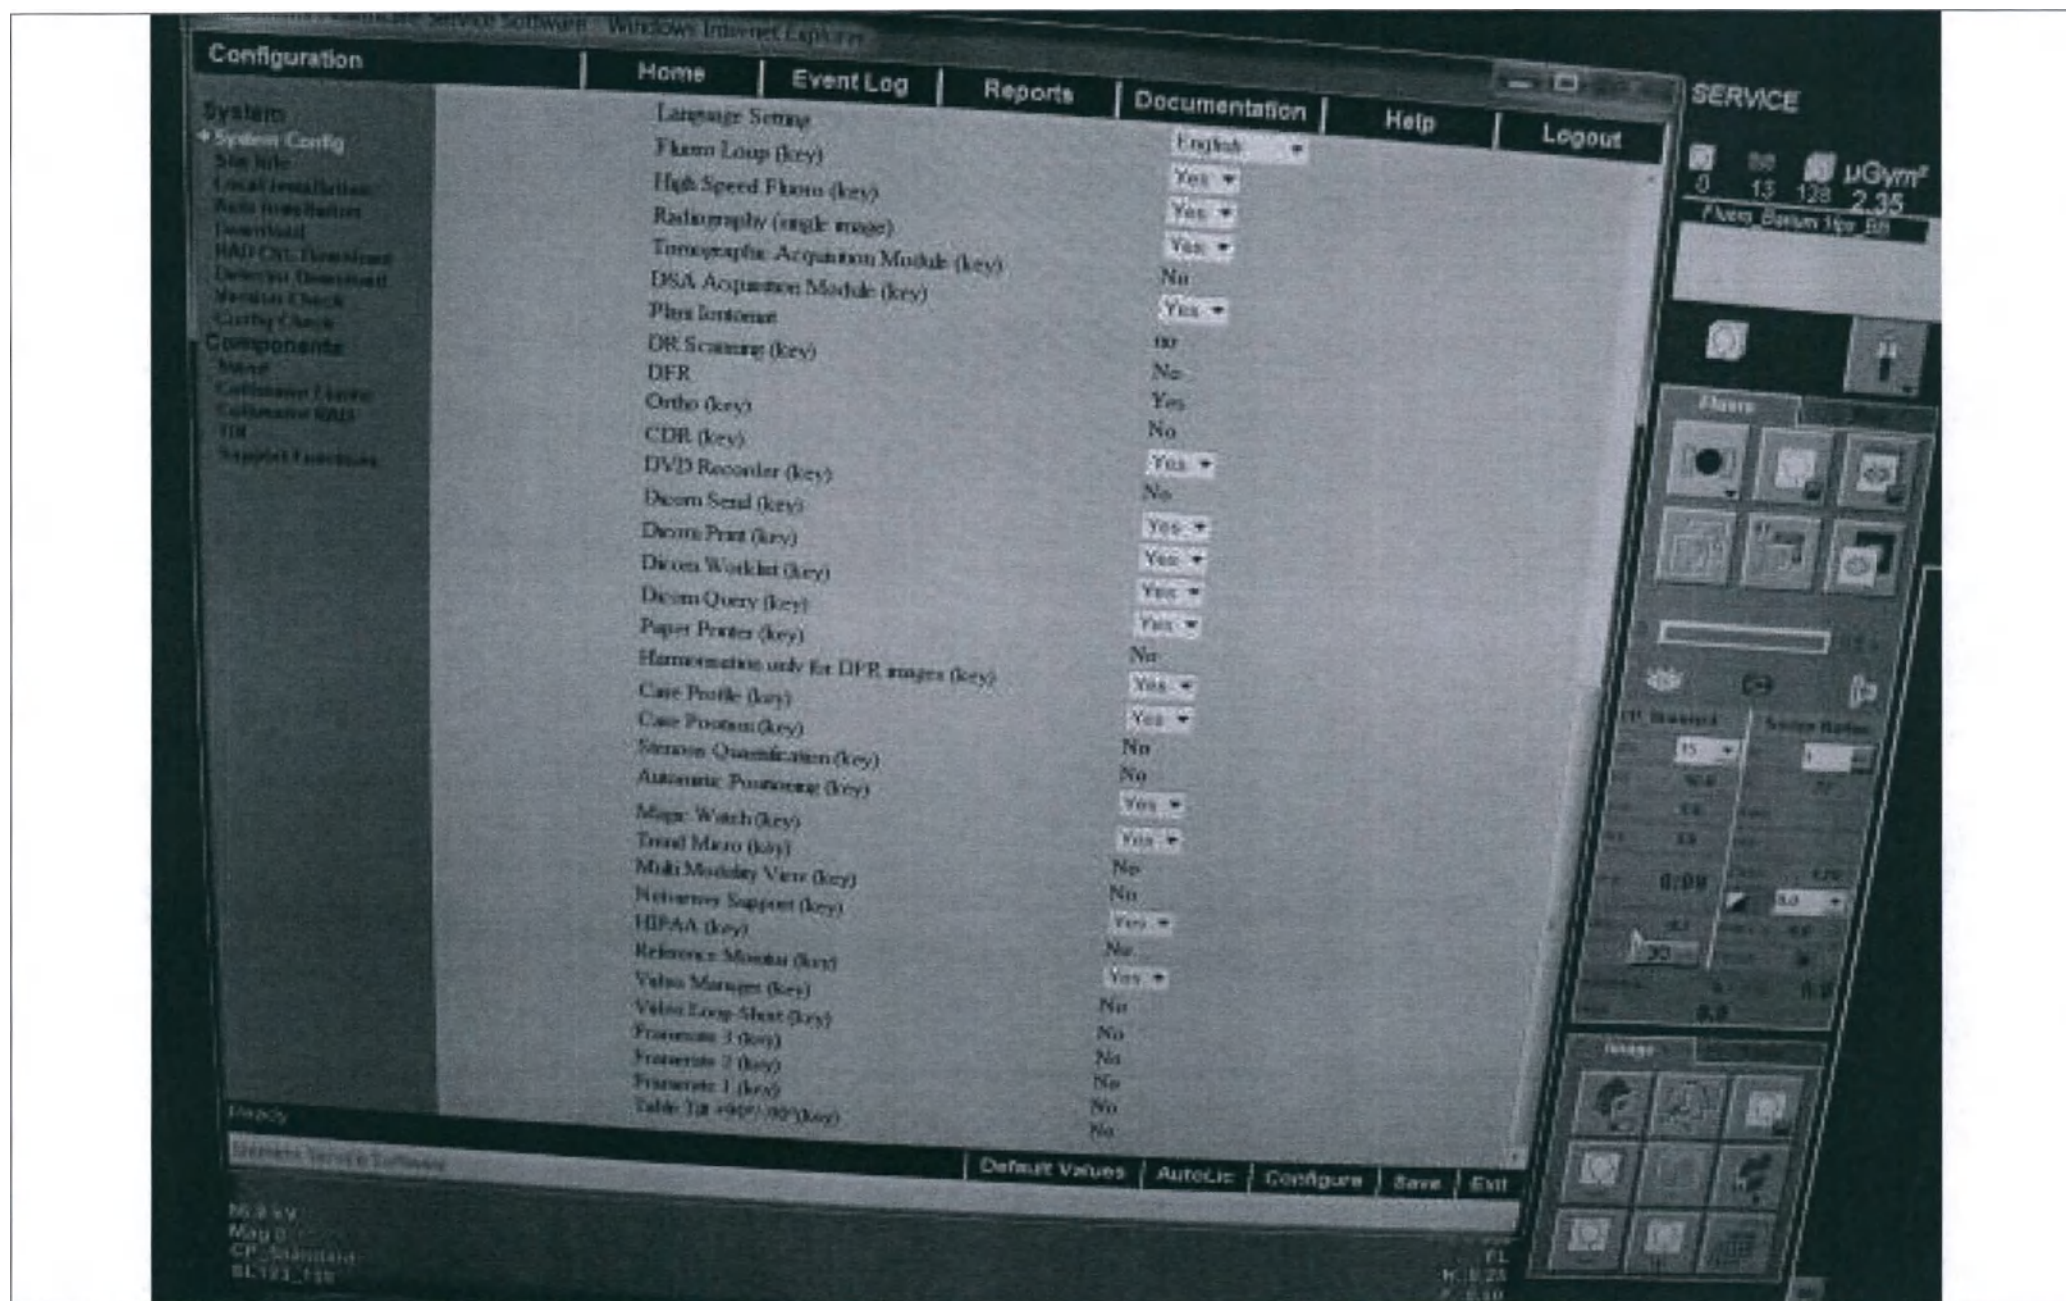


16. Лицензионный ключ для активации программного режима цифровой субтракционной ангиографии (DSA) .

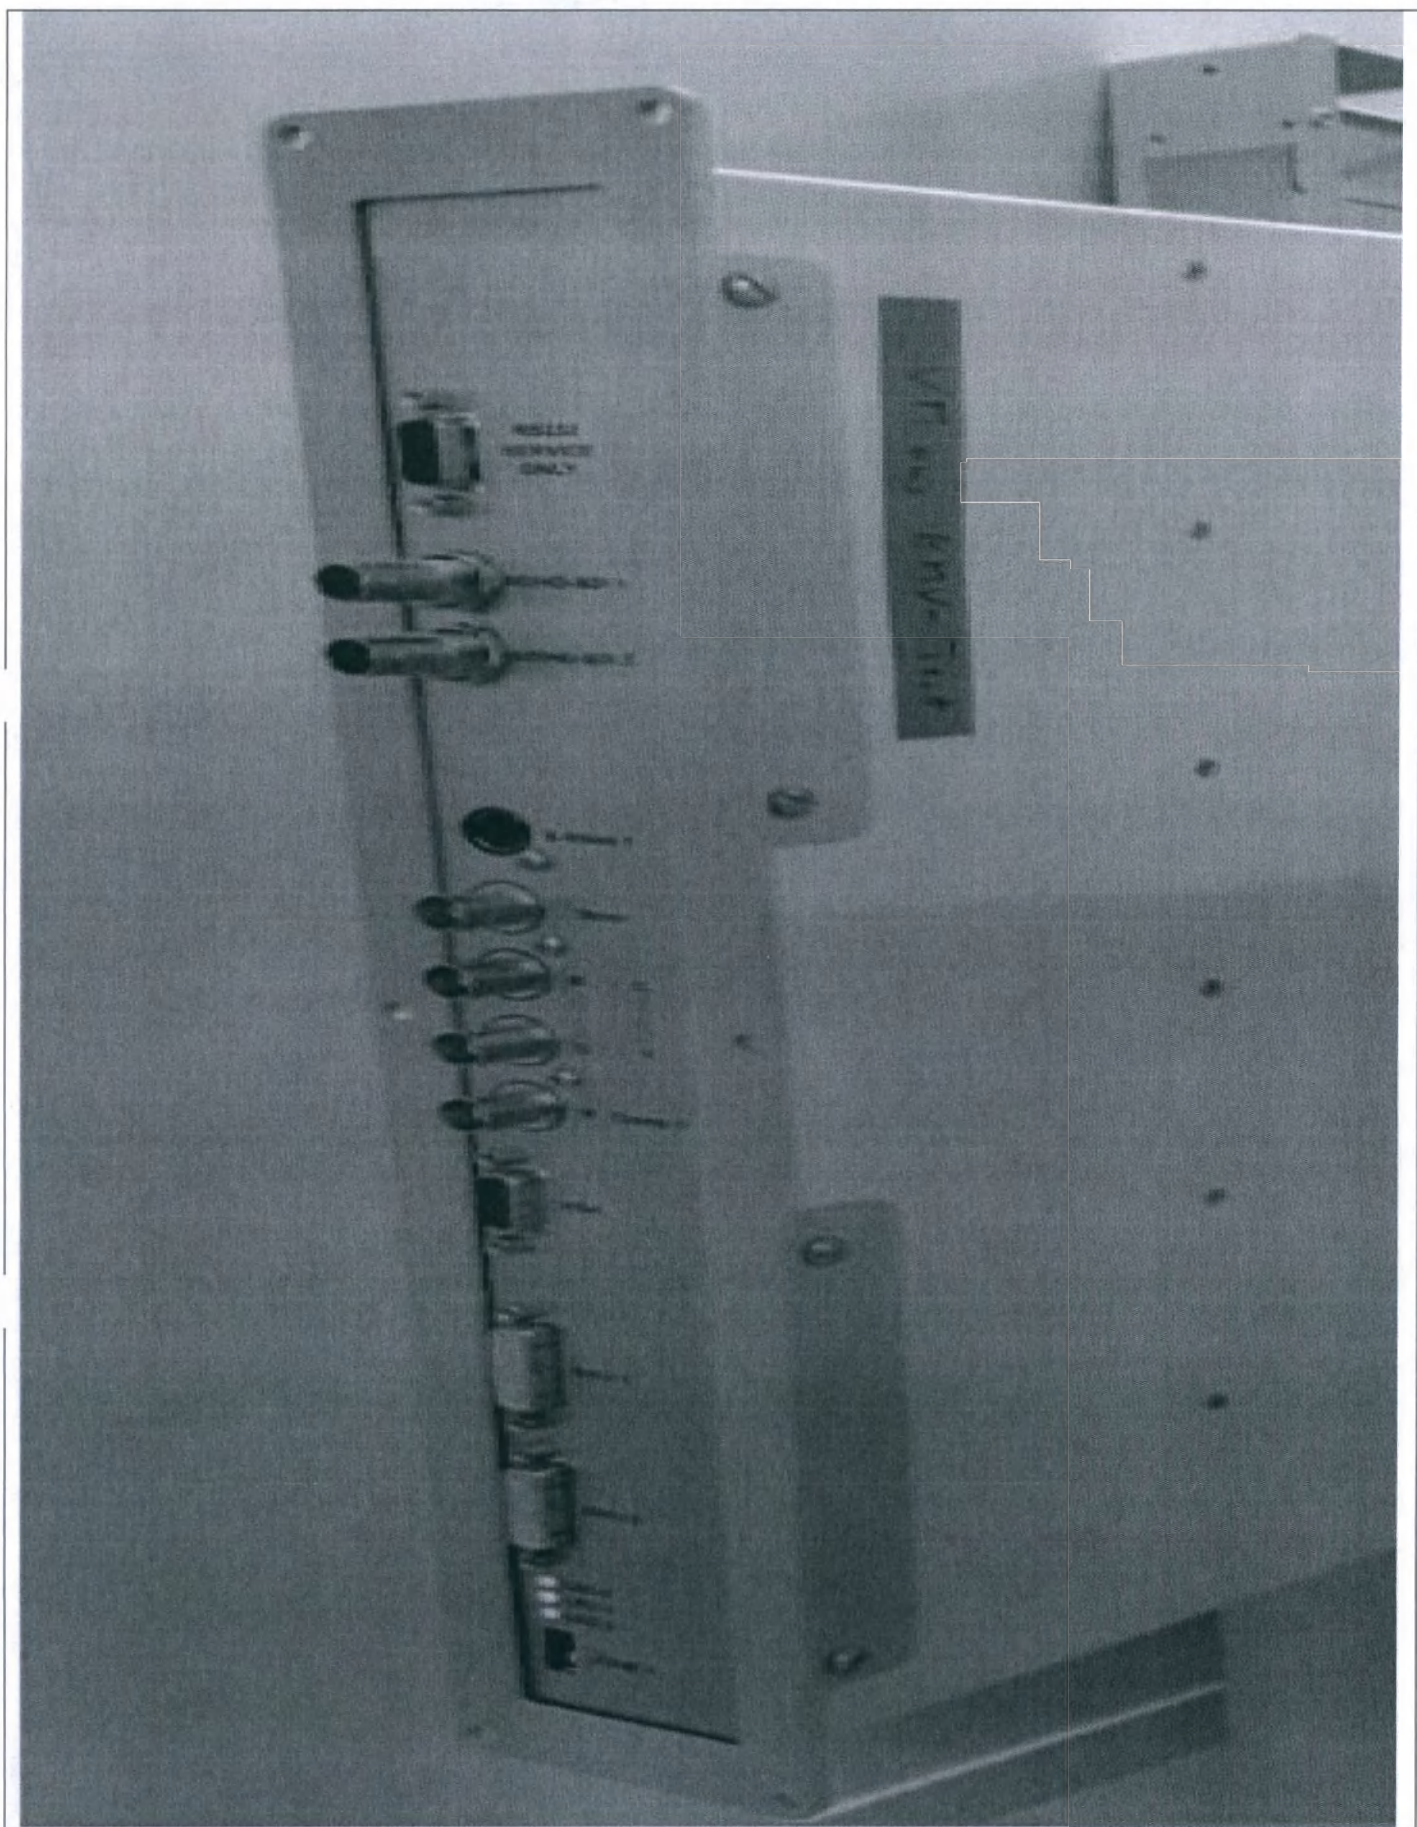

17. Интерфейс для подключения бумажного принтера и распечатки изображений.

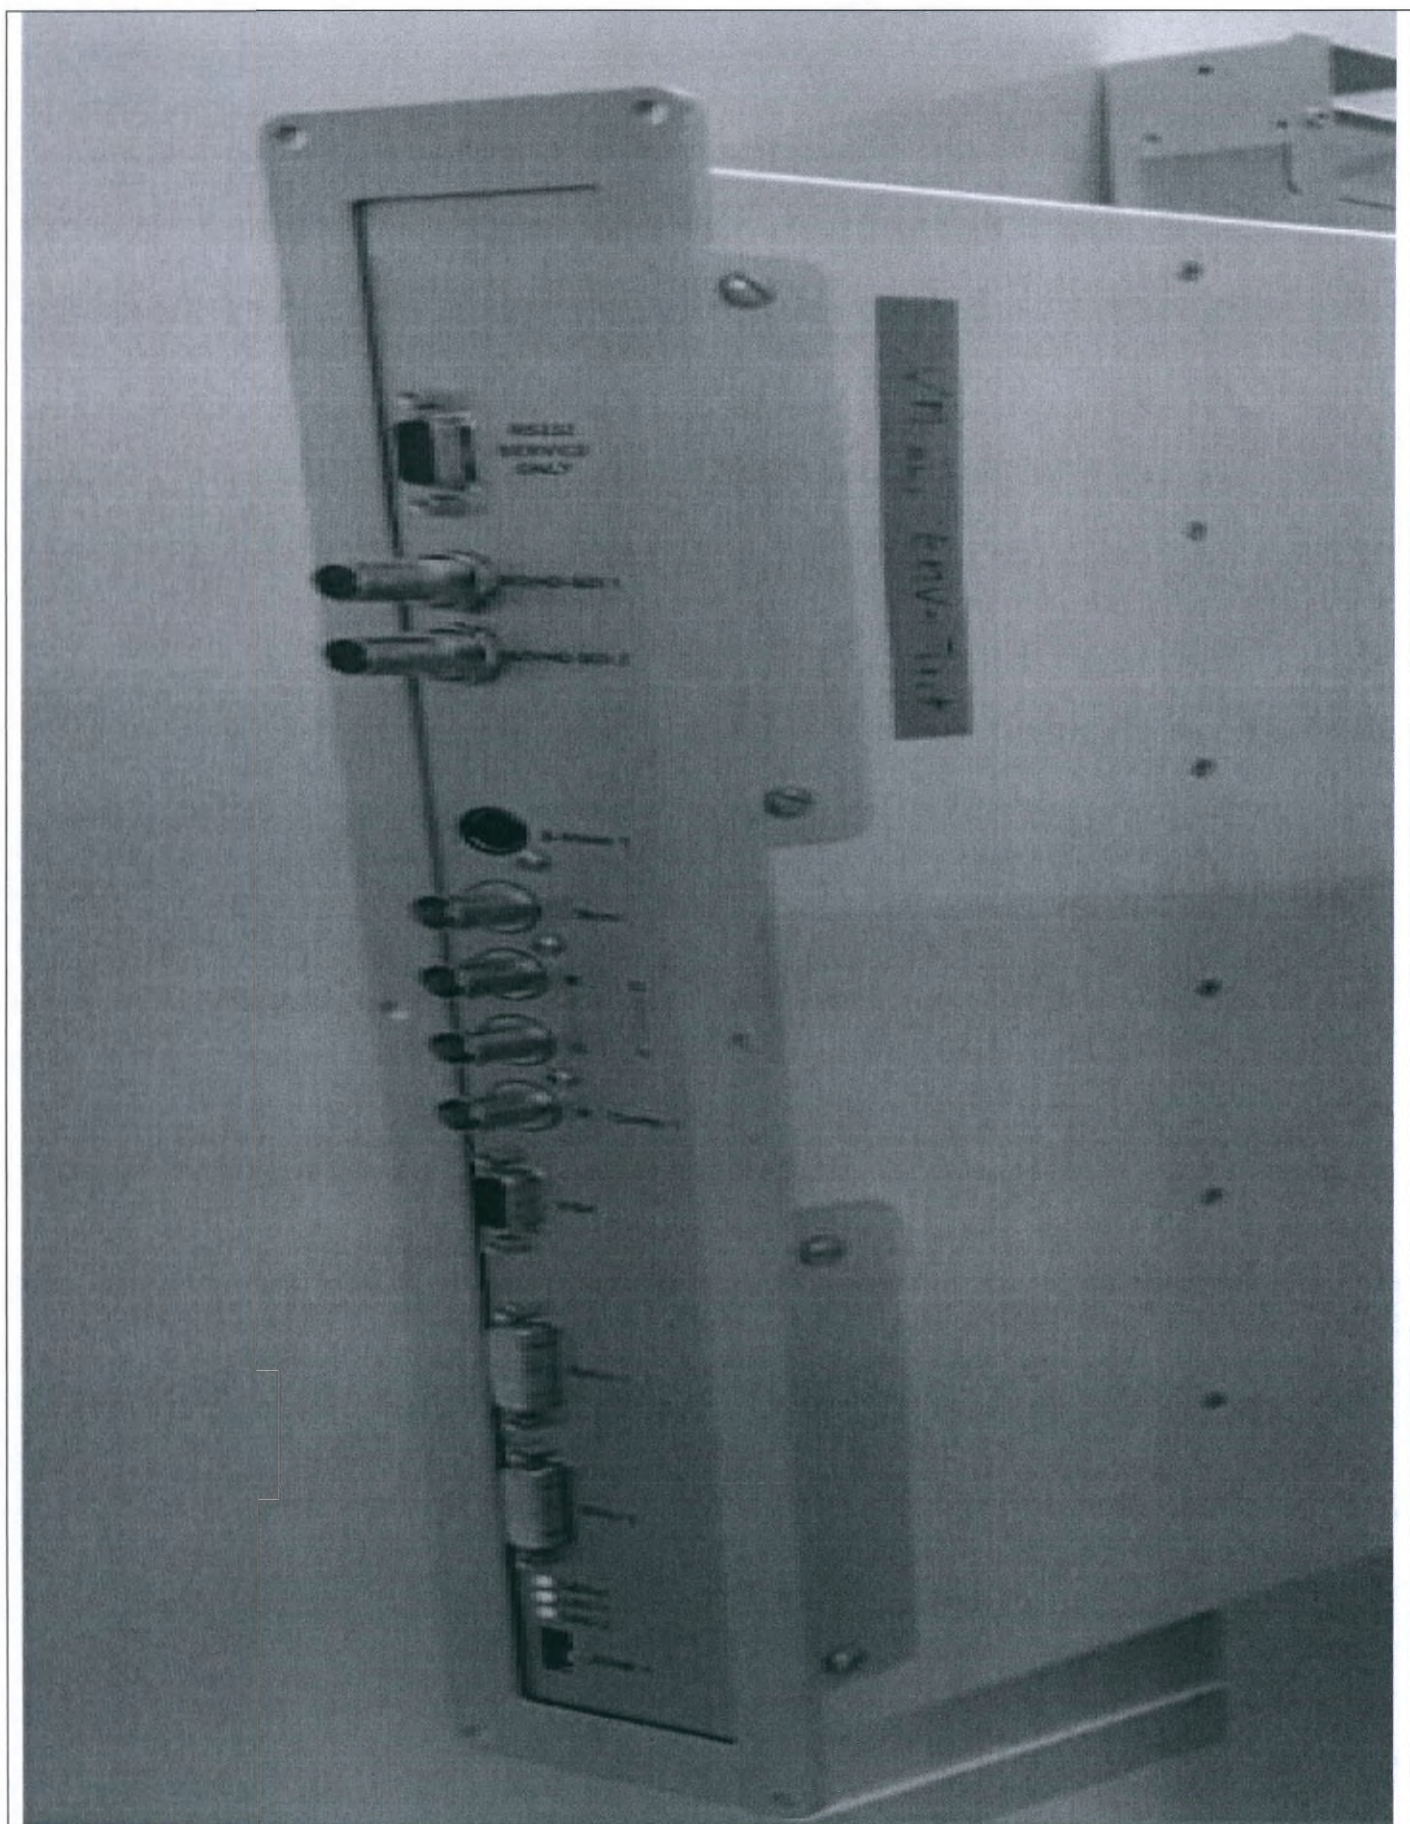


18. Внешний DVI интерфейс.

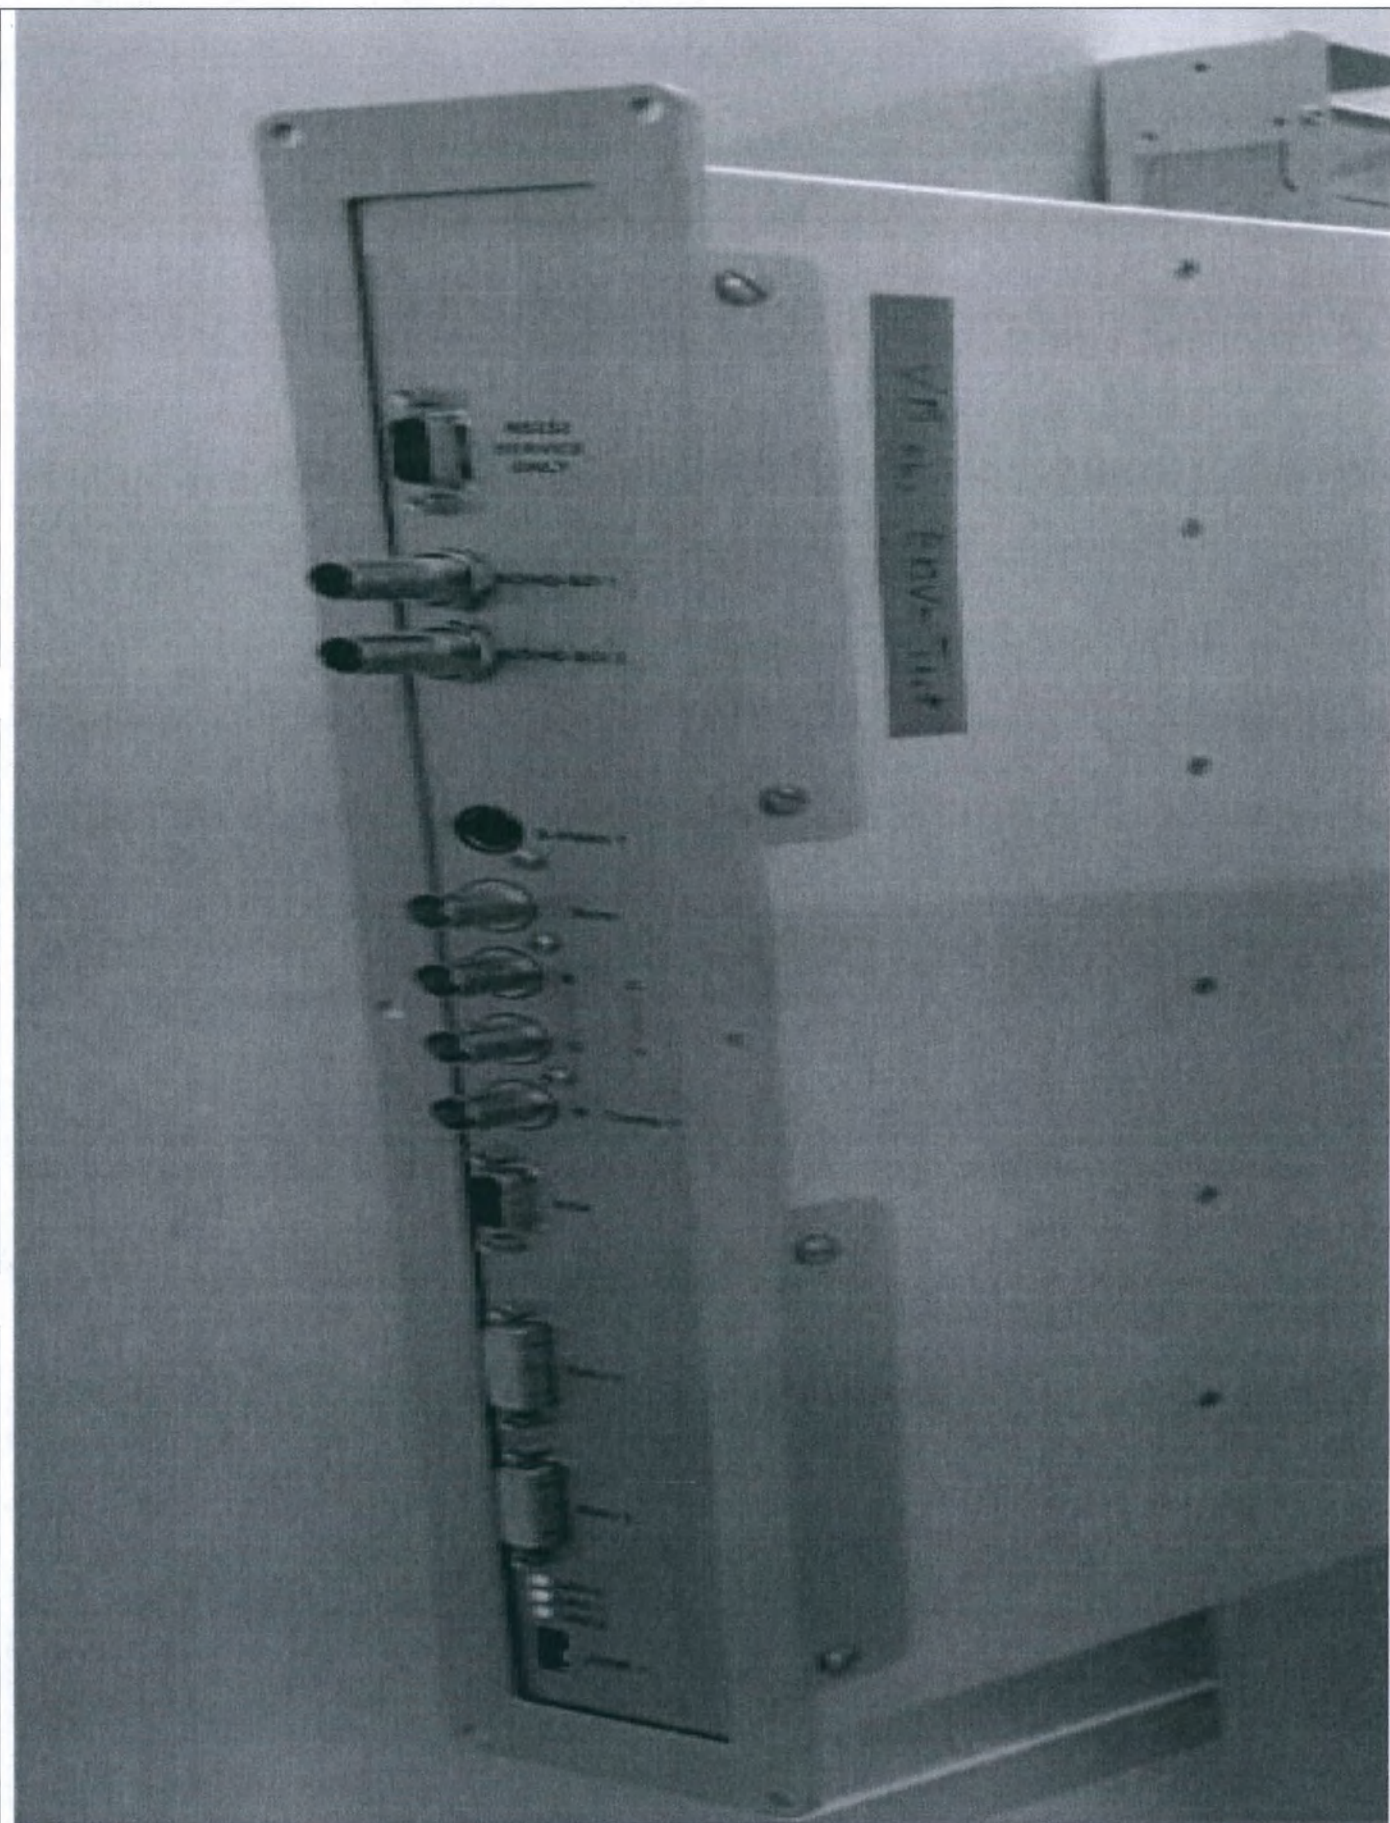


19. Интерфейс USB.




20. Выход для подключения DVD

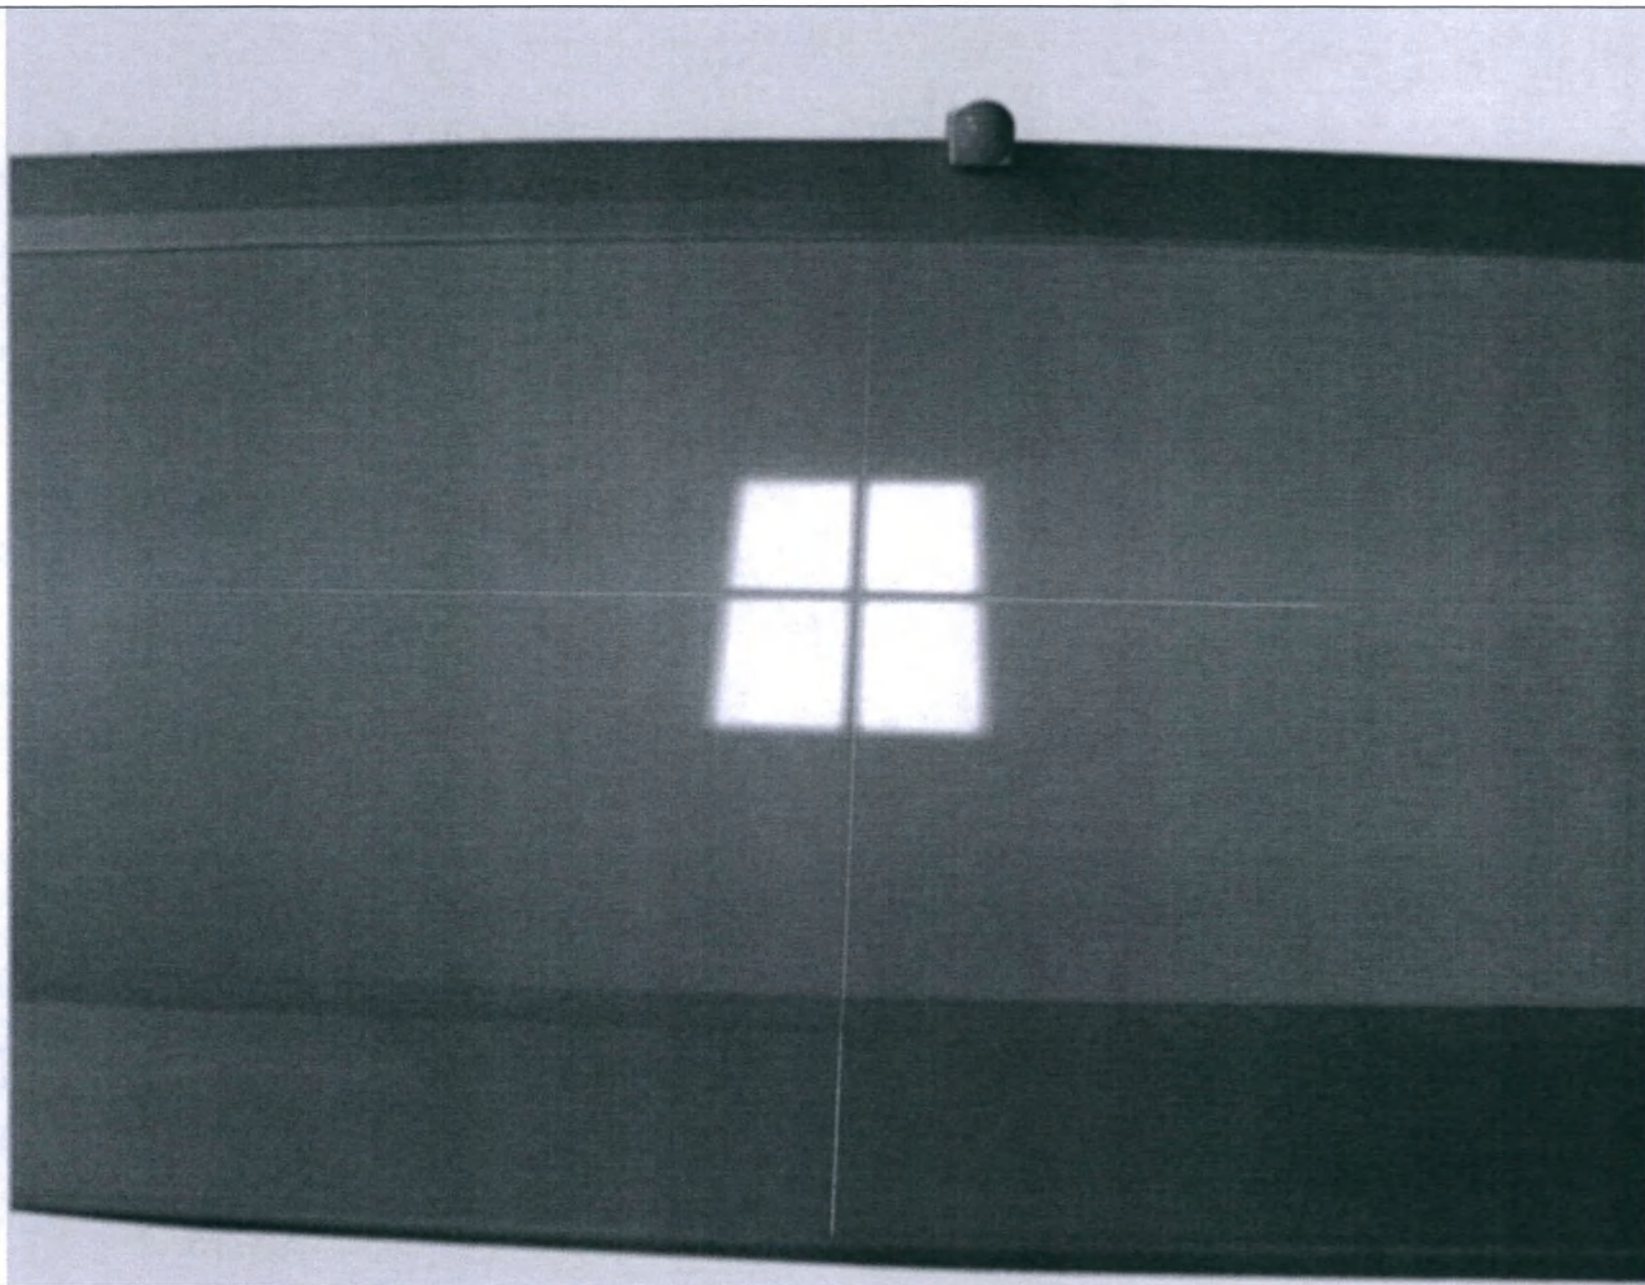


21. Лазерный штриховой оптический центратор

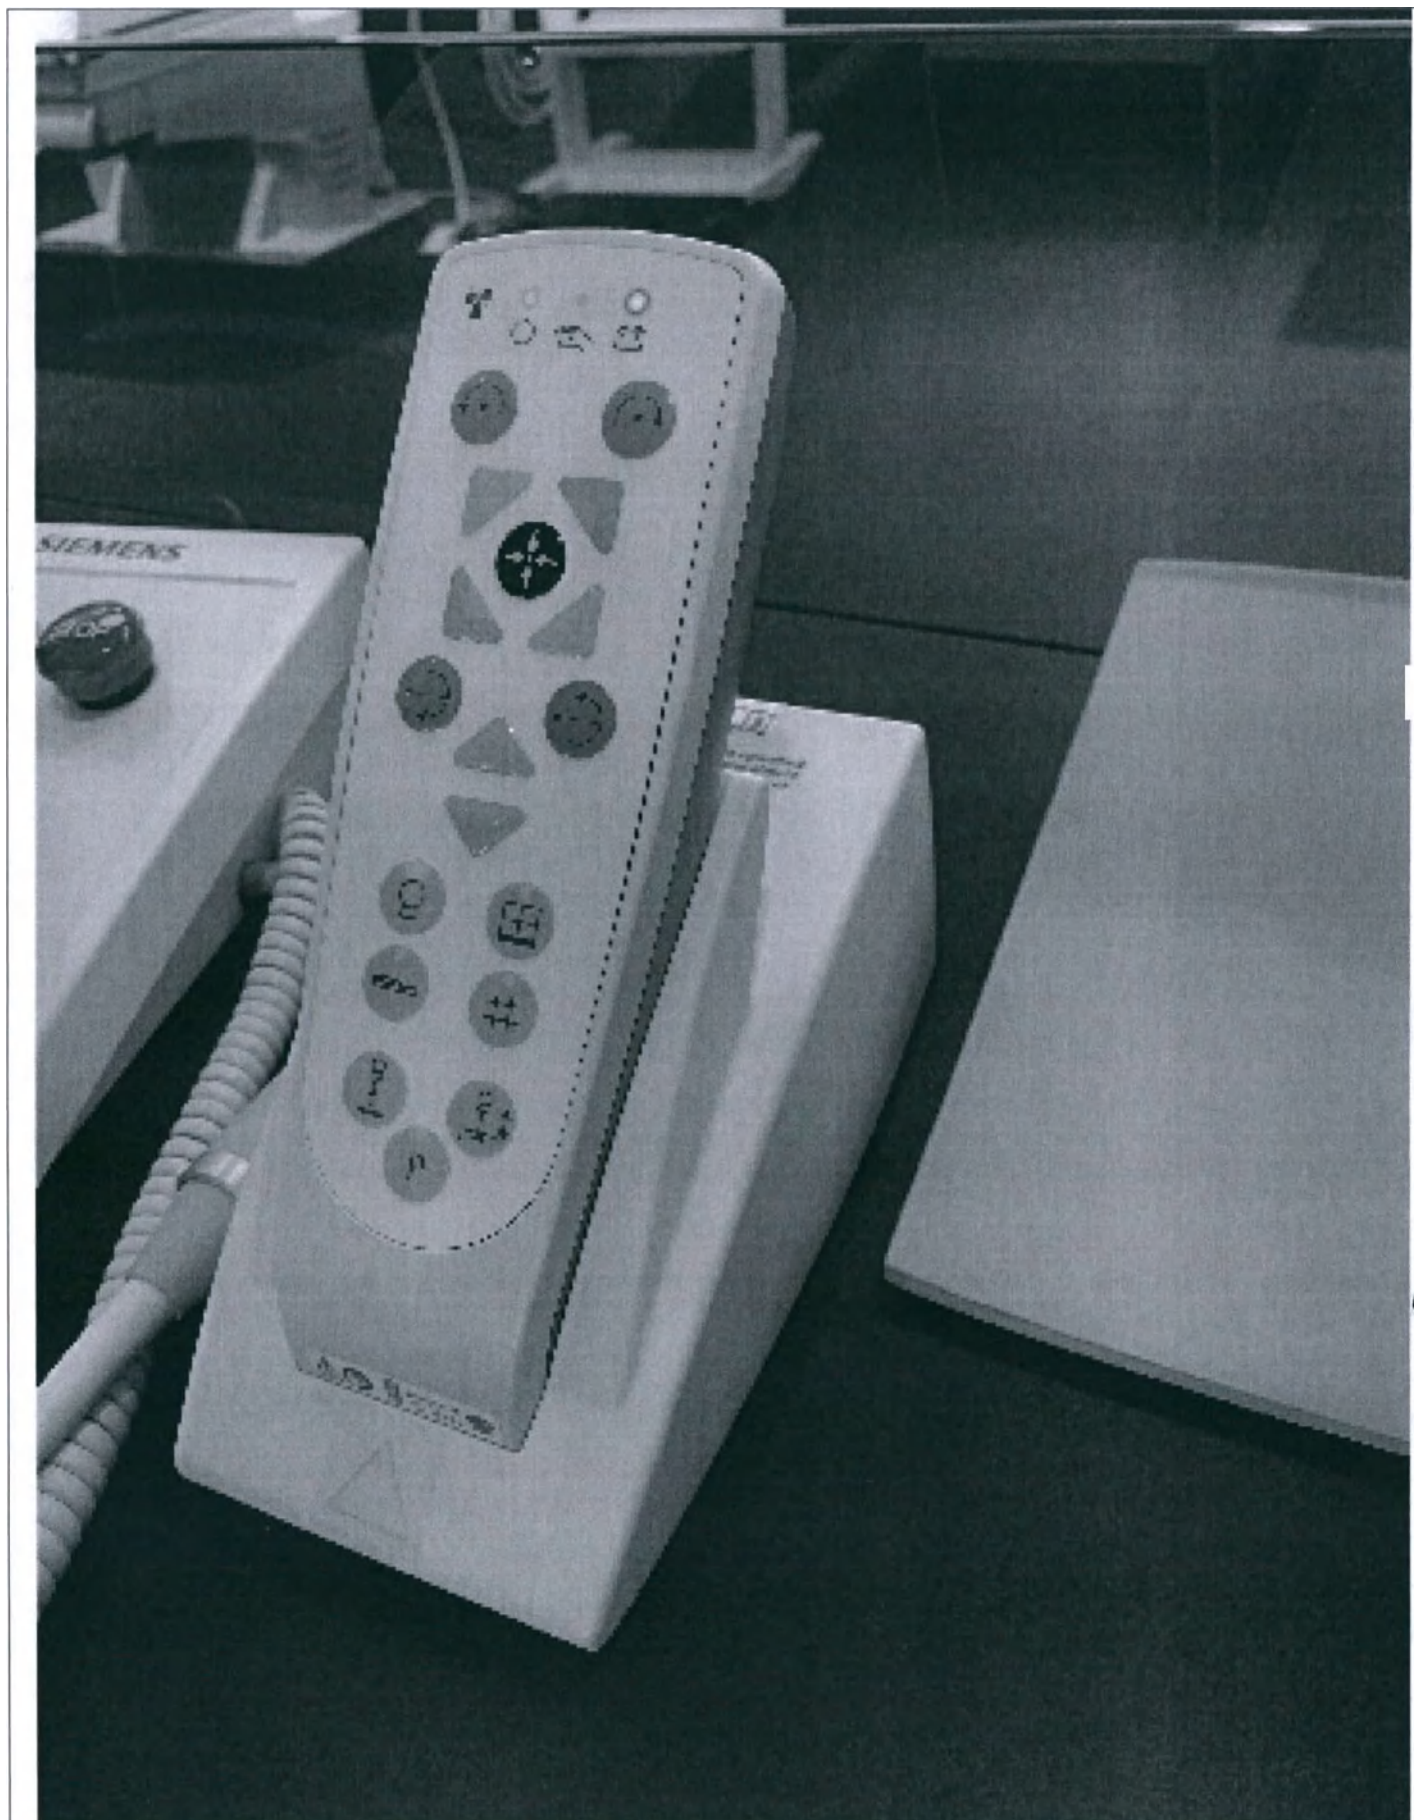


22. Ручной пульт дистанционного управления стойкой

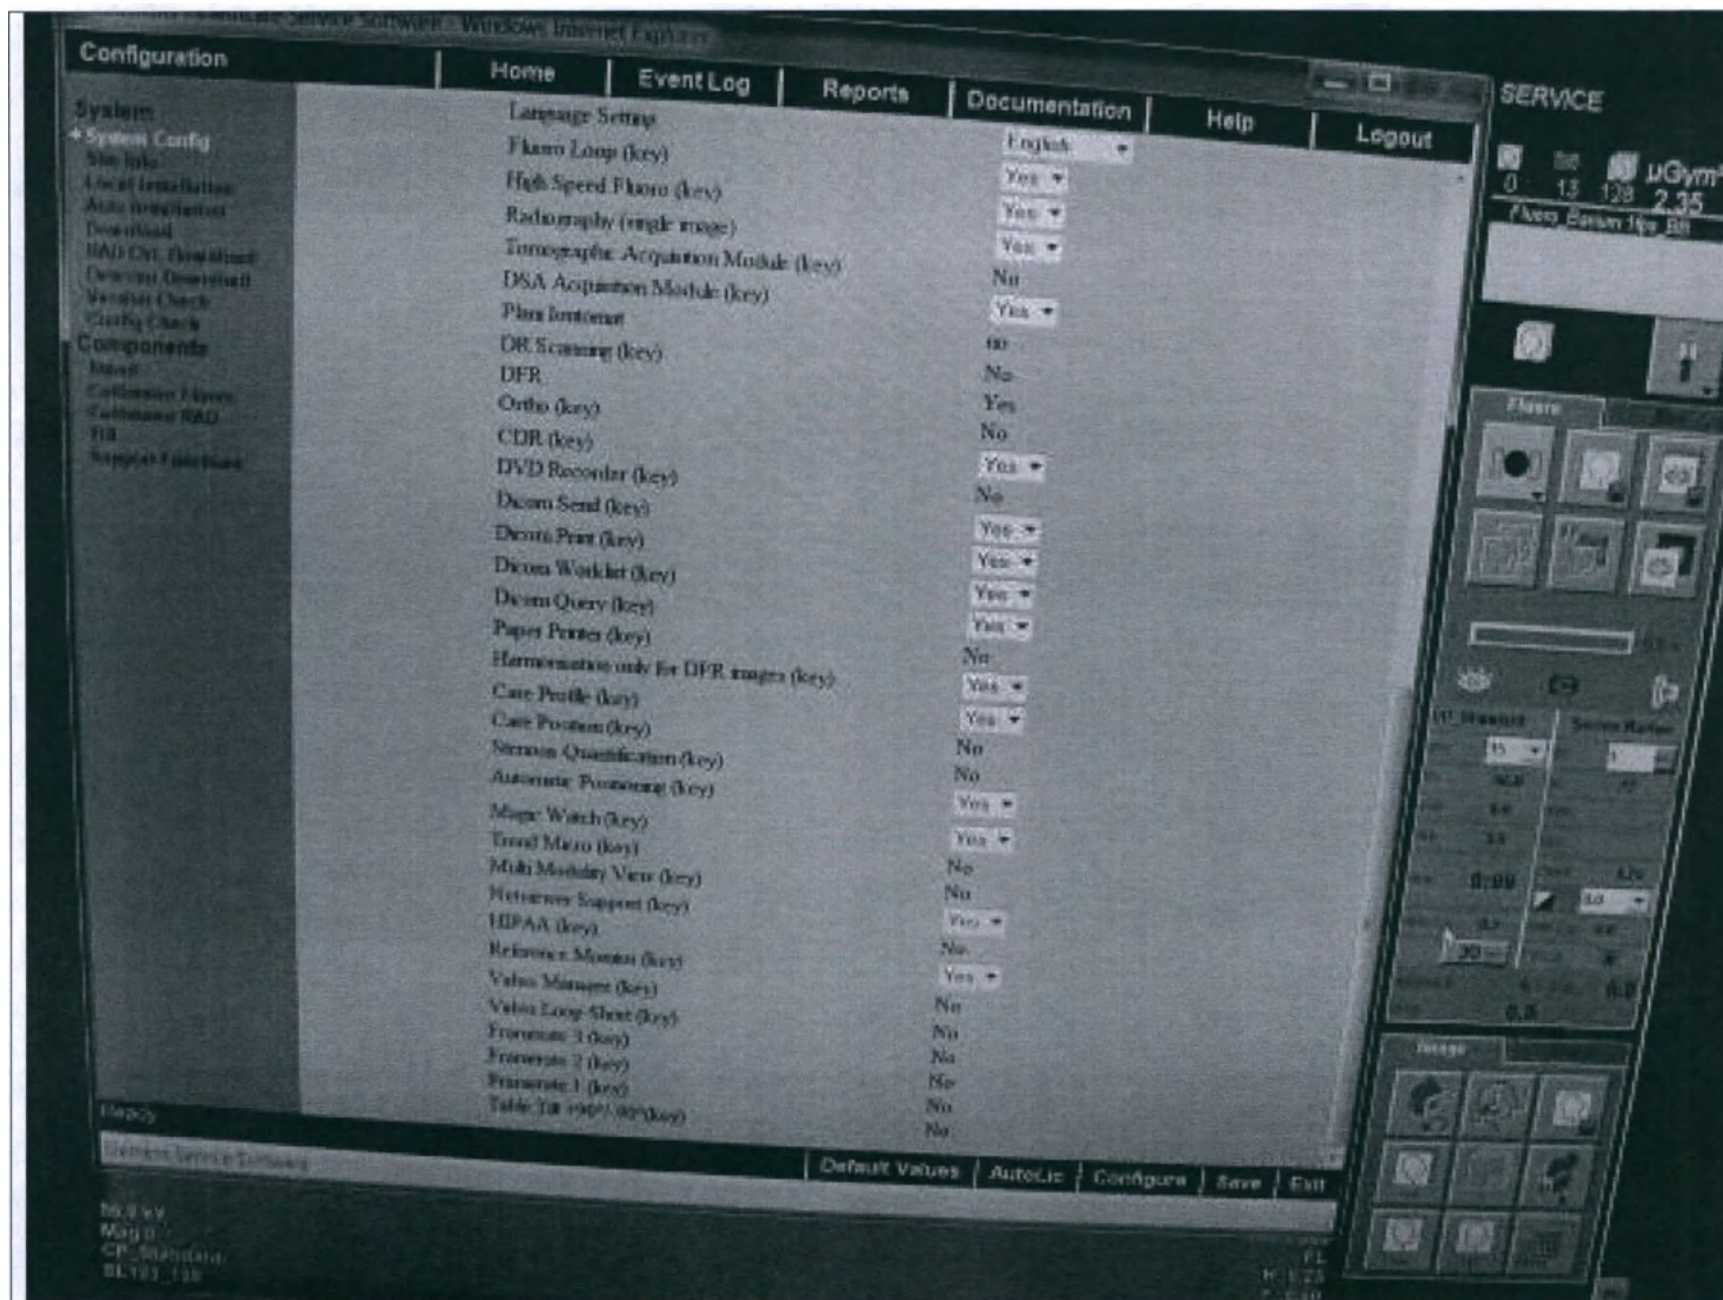


23. Лицензия для точки доступа WLAN.

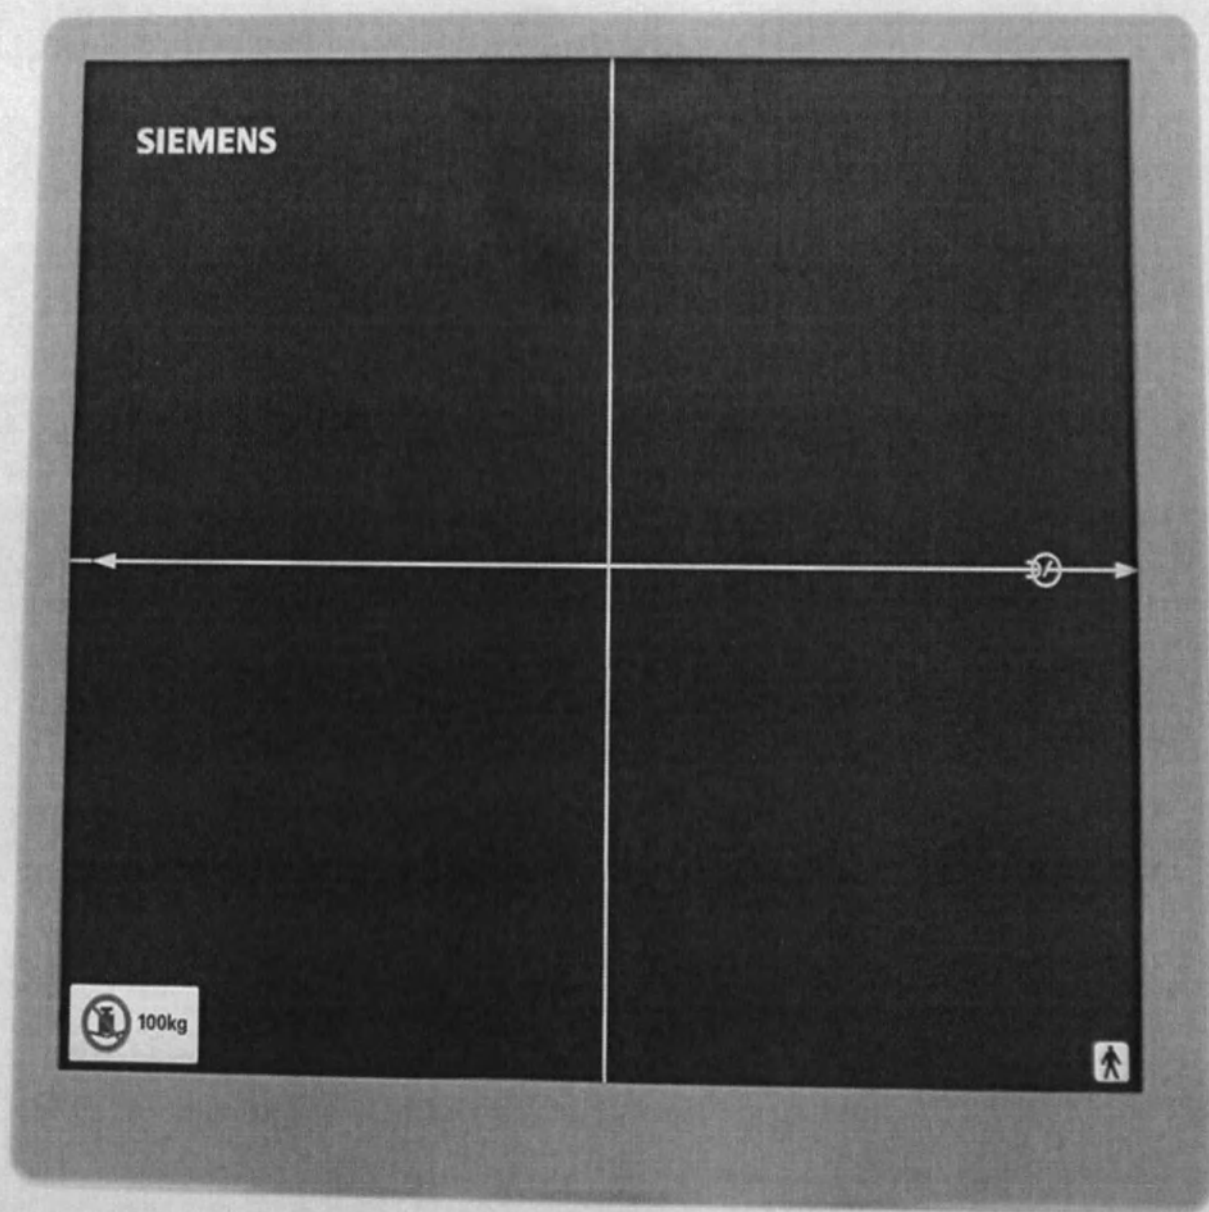


24. Съёмная отсеивающая решётка для детектора MAX wi-D (15/80, F115)

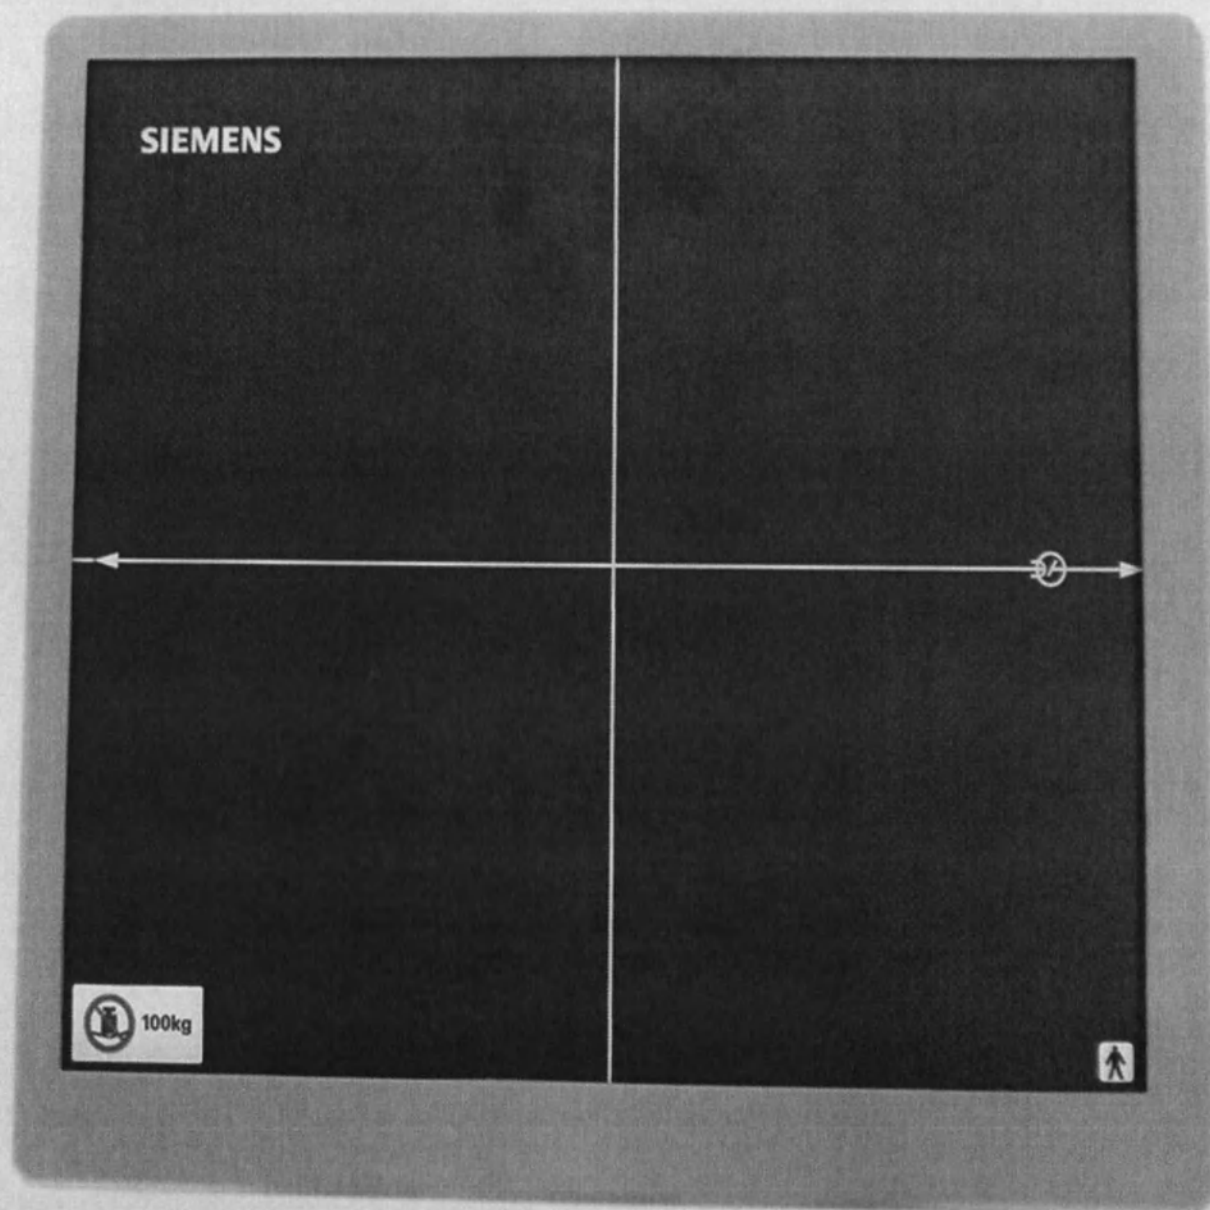


25. Съёмная отсеивающая решётка для детектора MAX wi-D (5/85, F115)

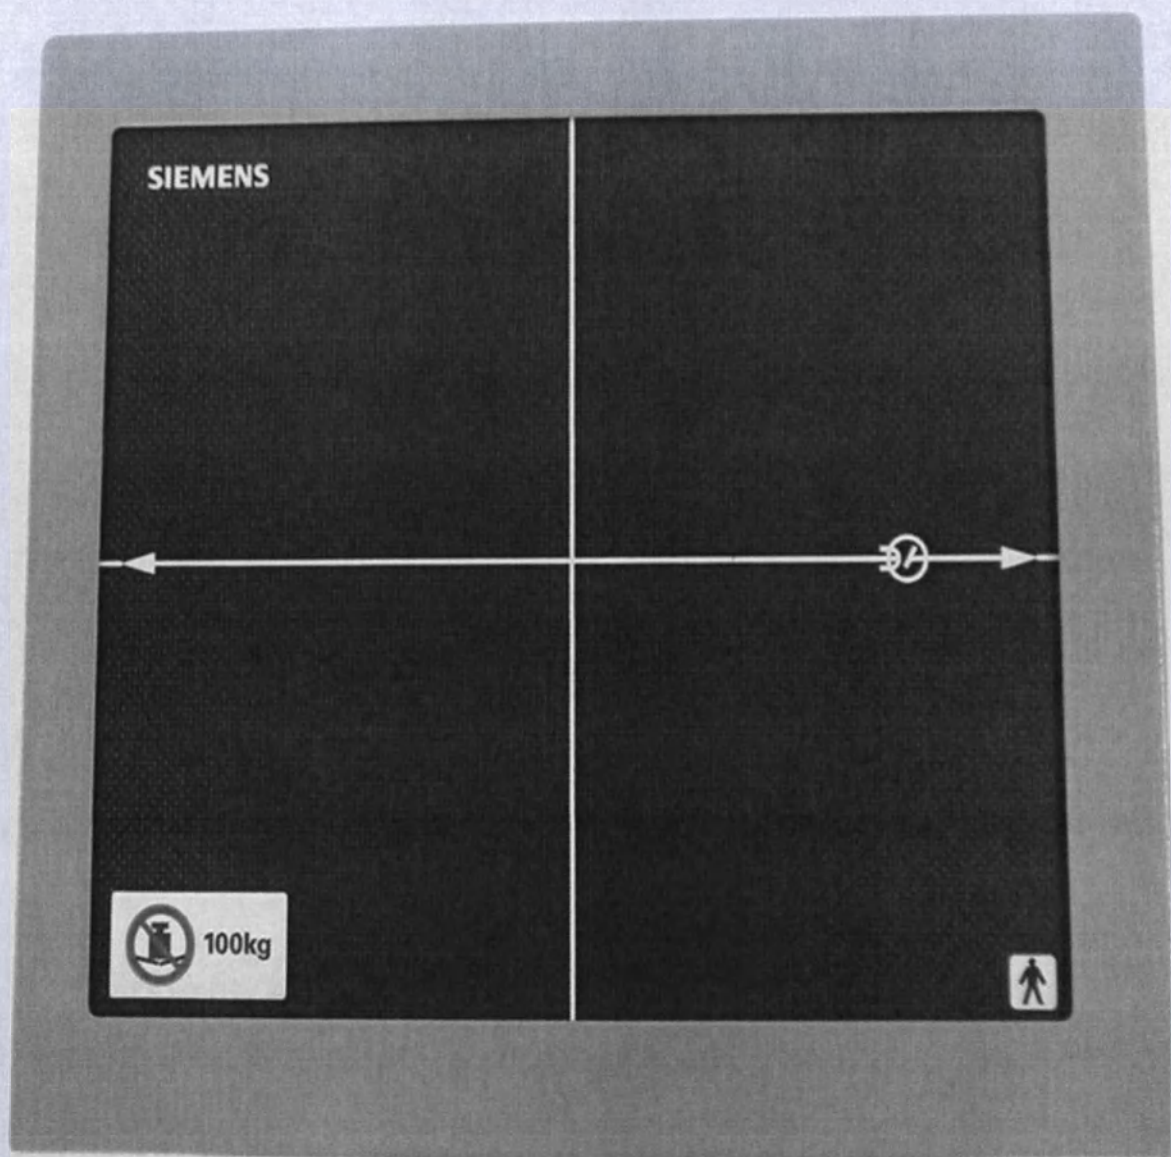

26. Съёмная отсеивающая решётка для детектора MAX mini (5/85, F115)ъемная решетка 5/85 f 115 для MAX wi-D mini.

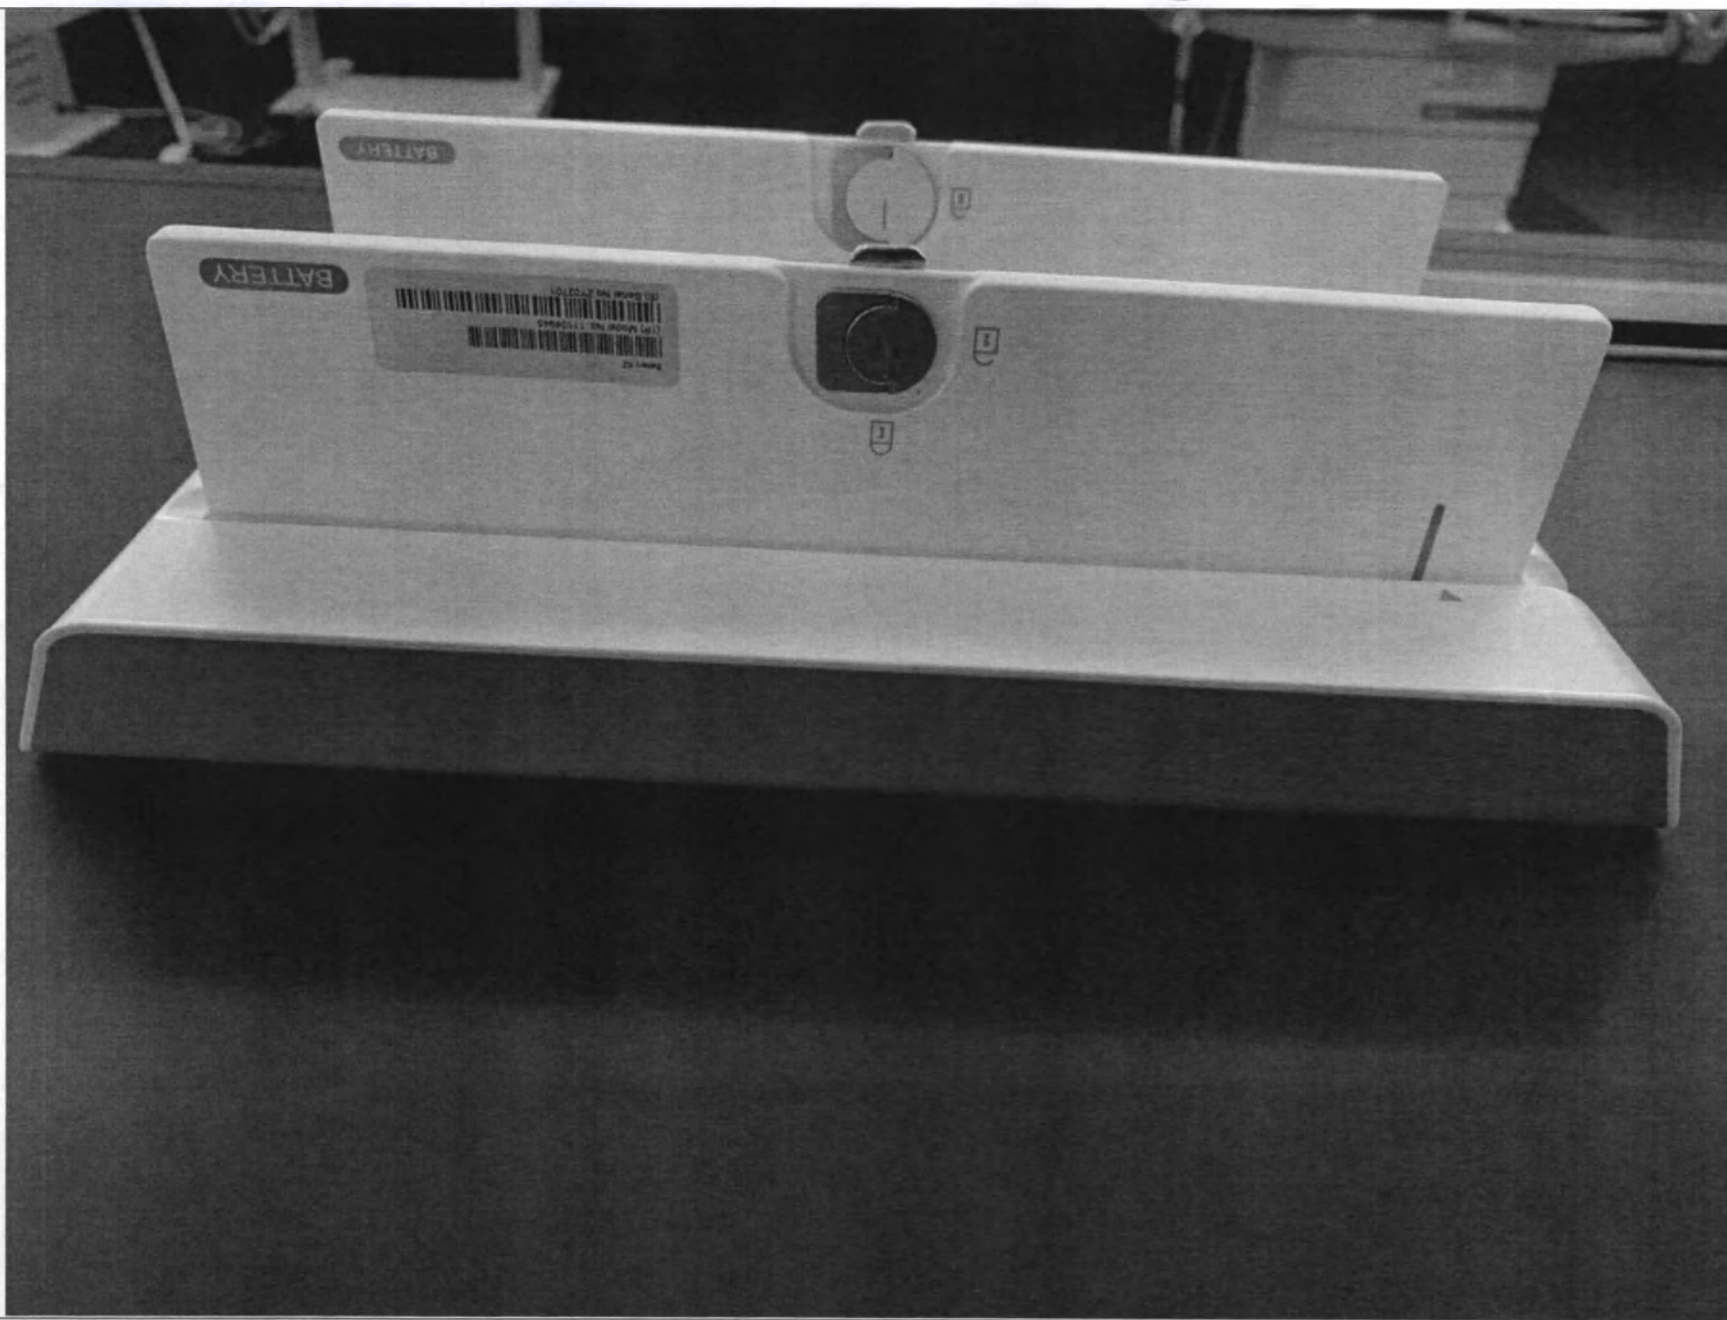

27. Зарядное устройство для детекторов.

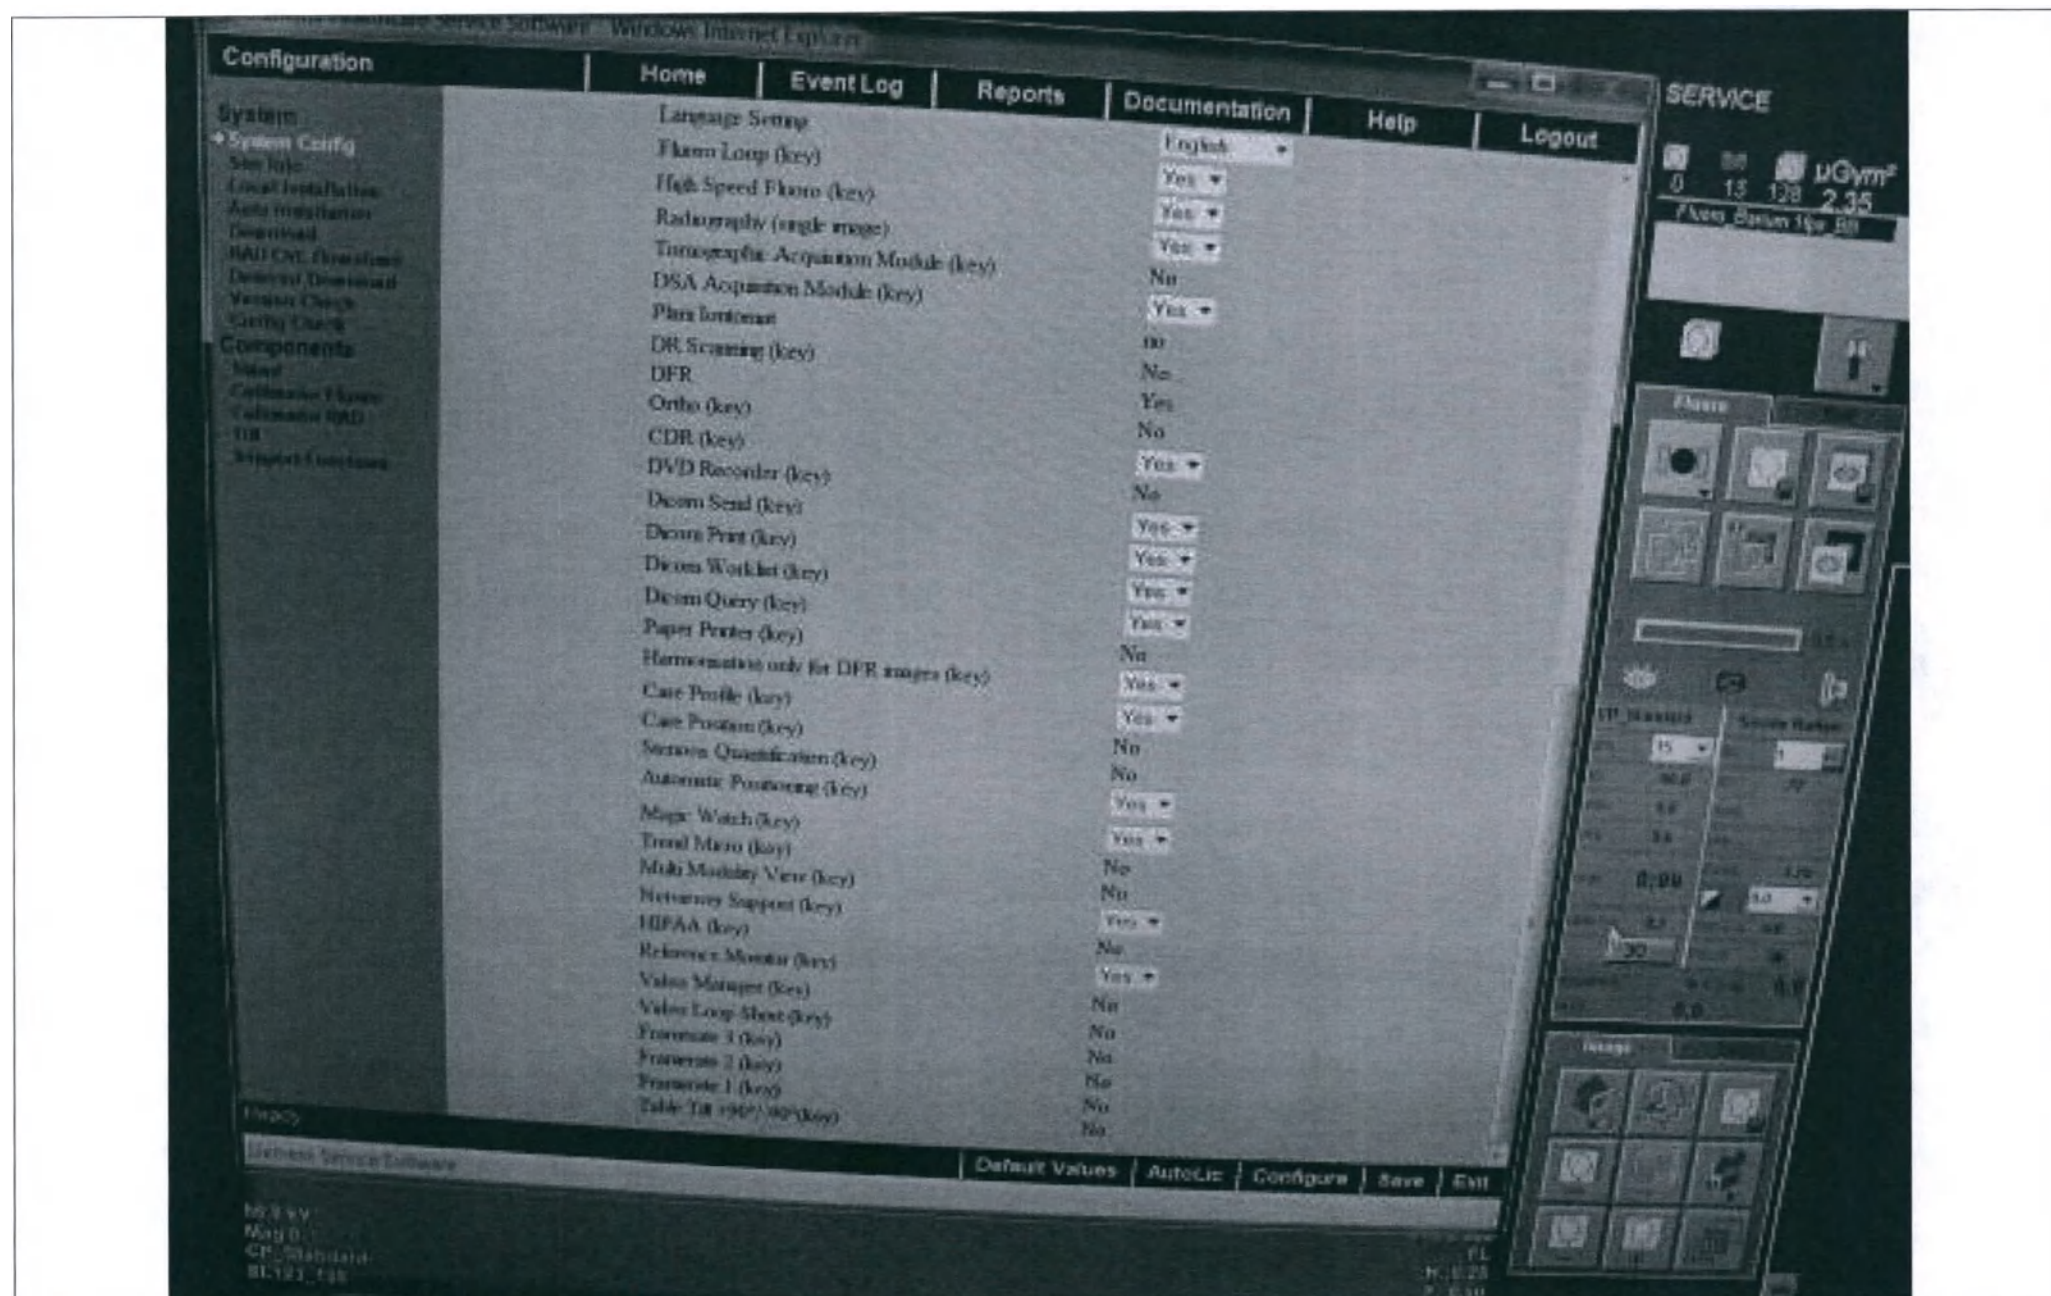


28. Лицензионный ключ для активации программного режима получения изображений в автоматическом режиме Ortho




30. Переговорное устройство врач - пациент




31. Напольная педаль для переговорного устройства.

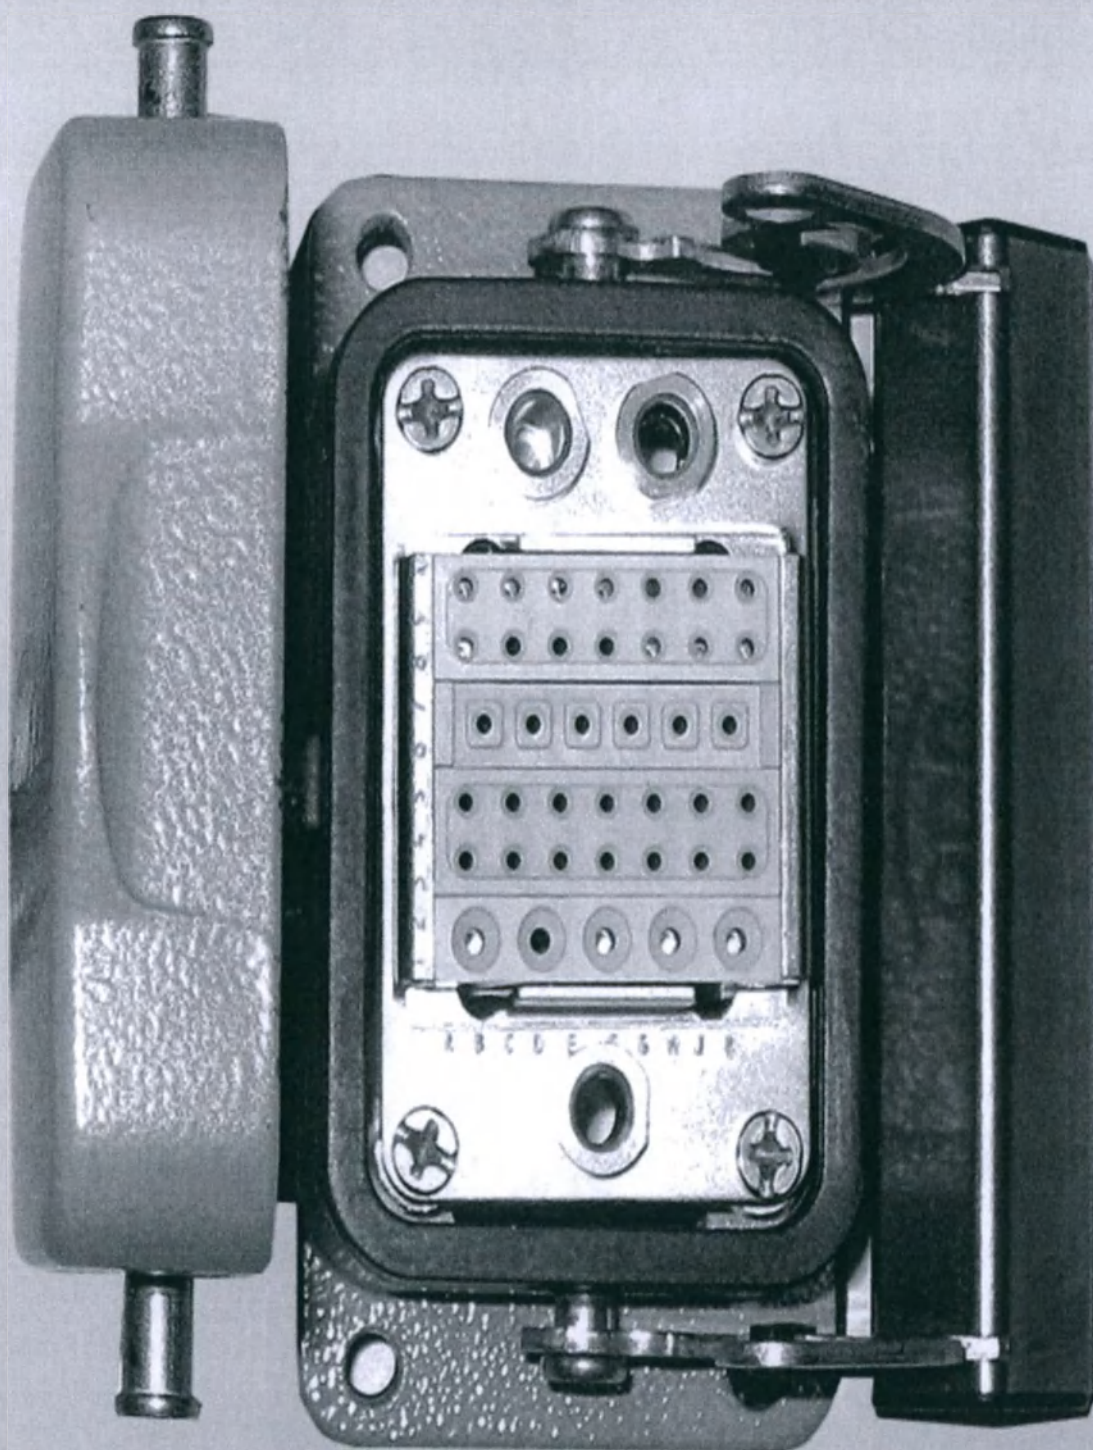


32. Гнездо для штекера инжектора.

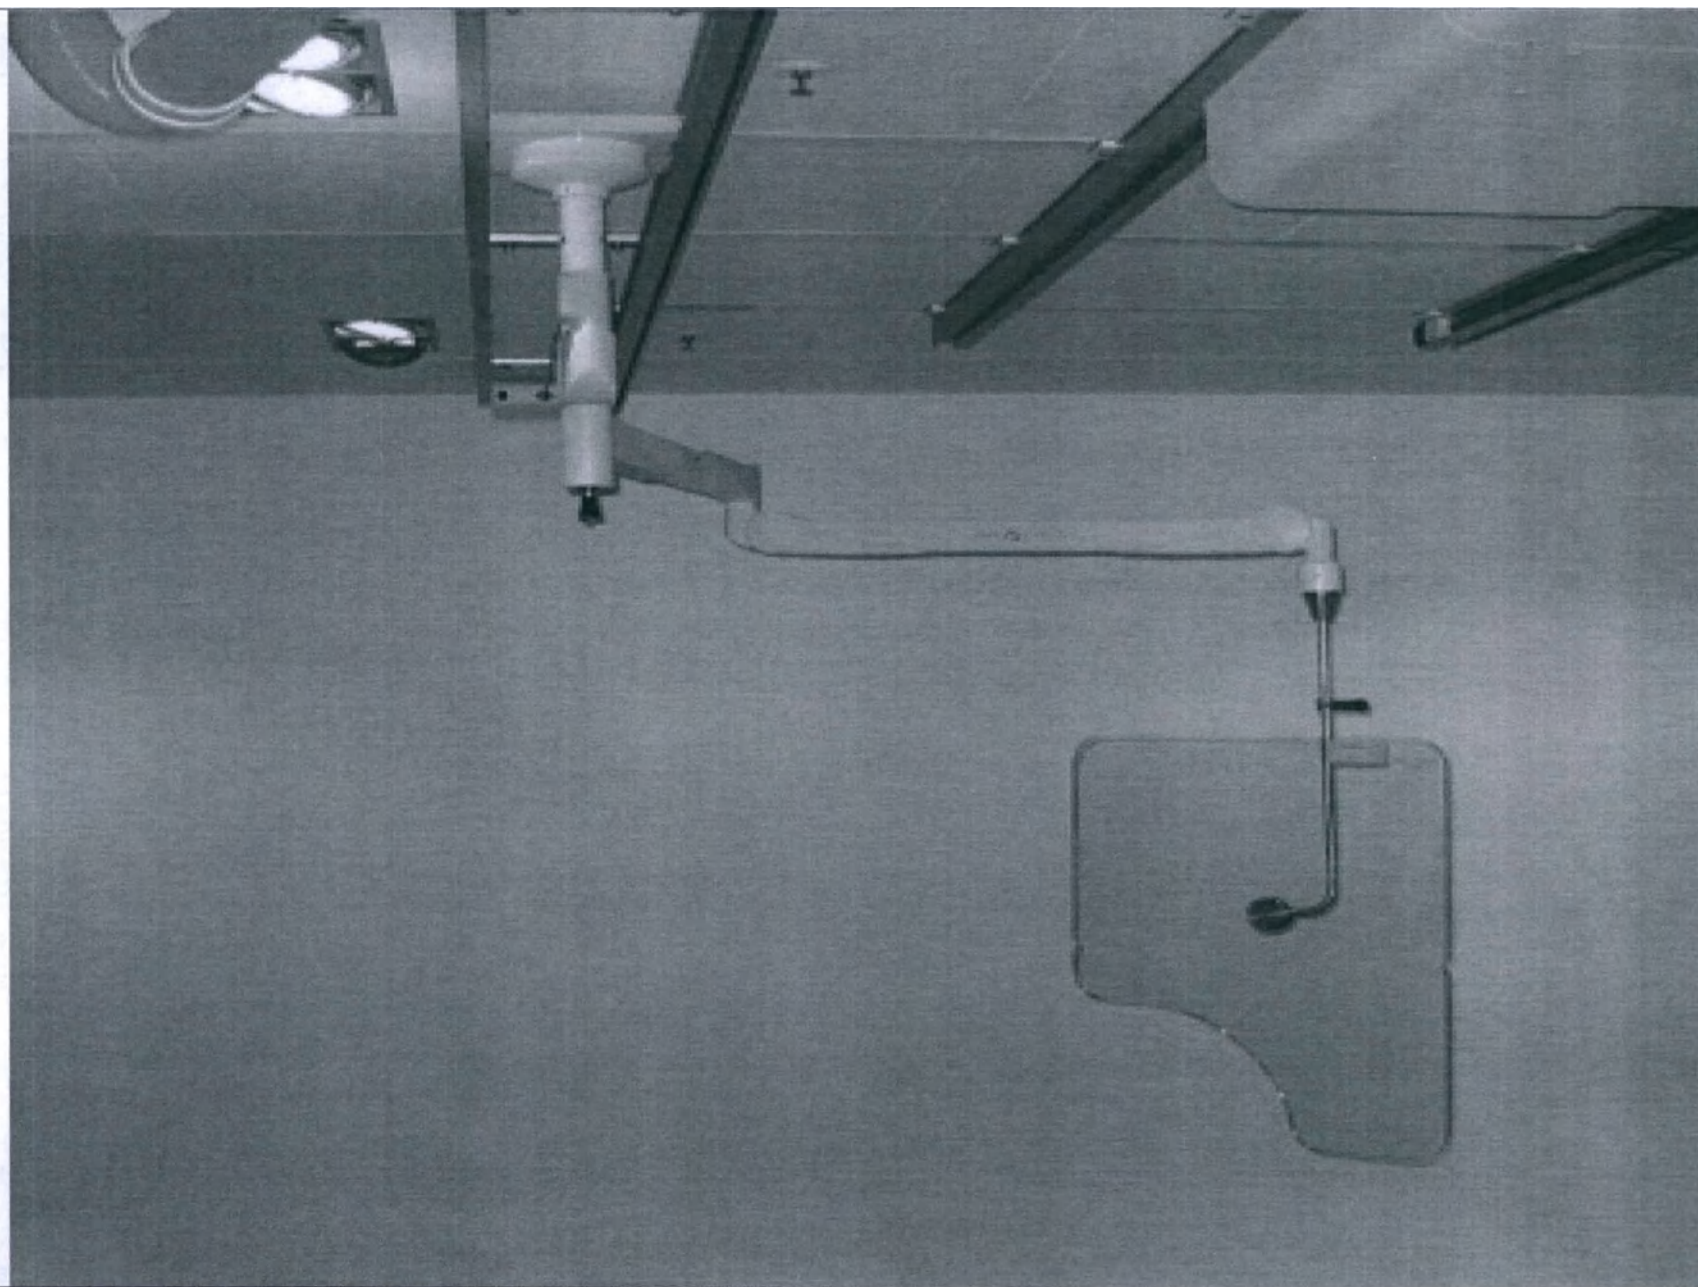

33. Защита от облучения для верхней части тела .

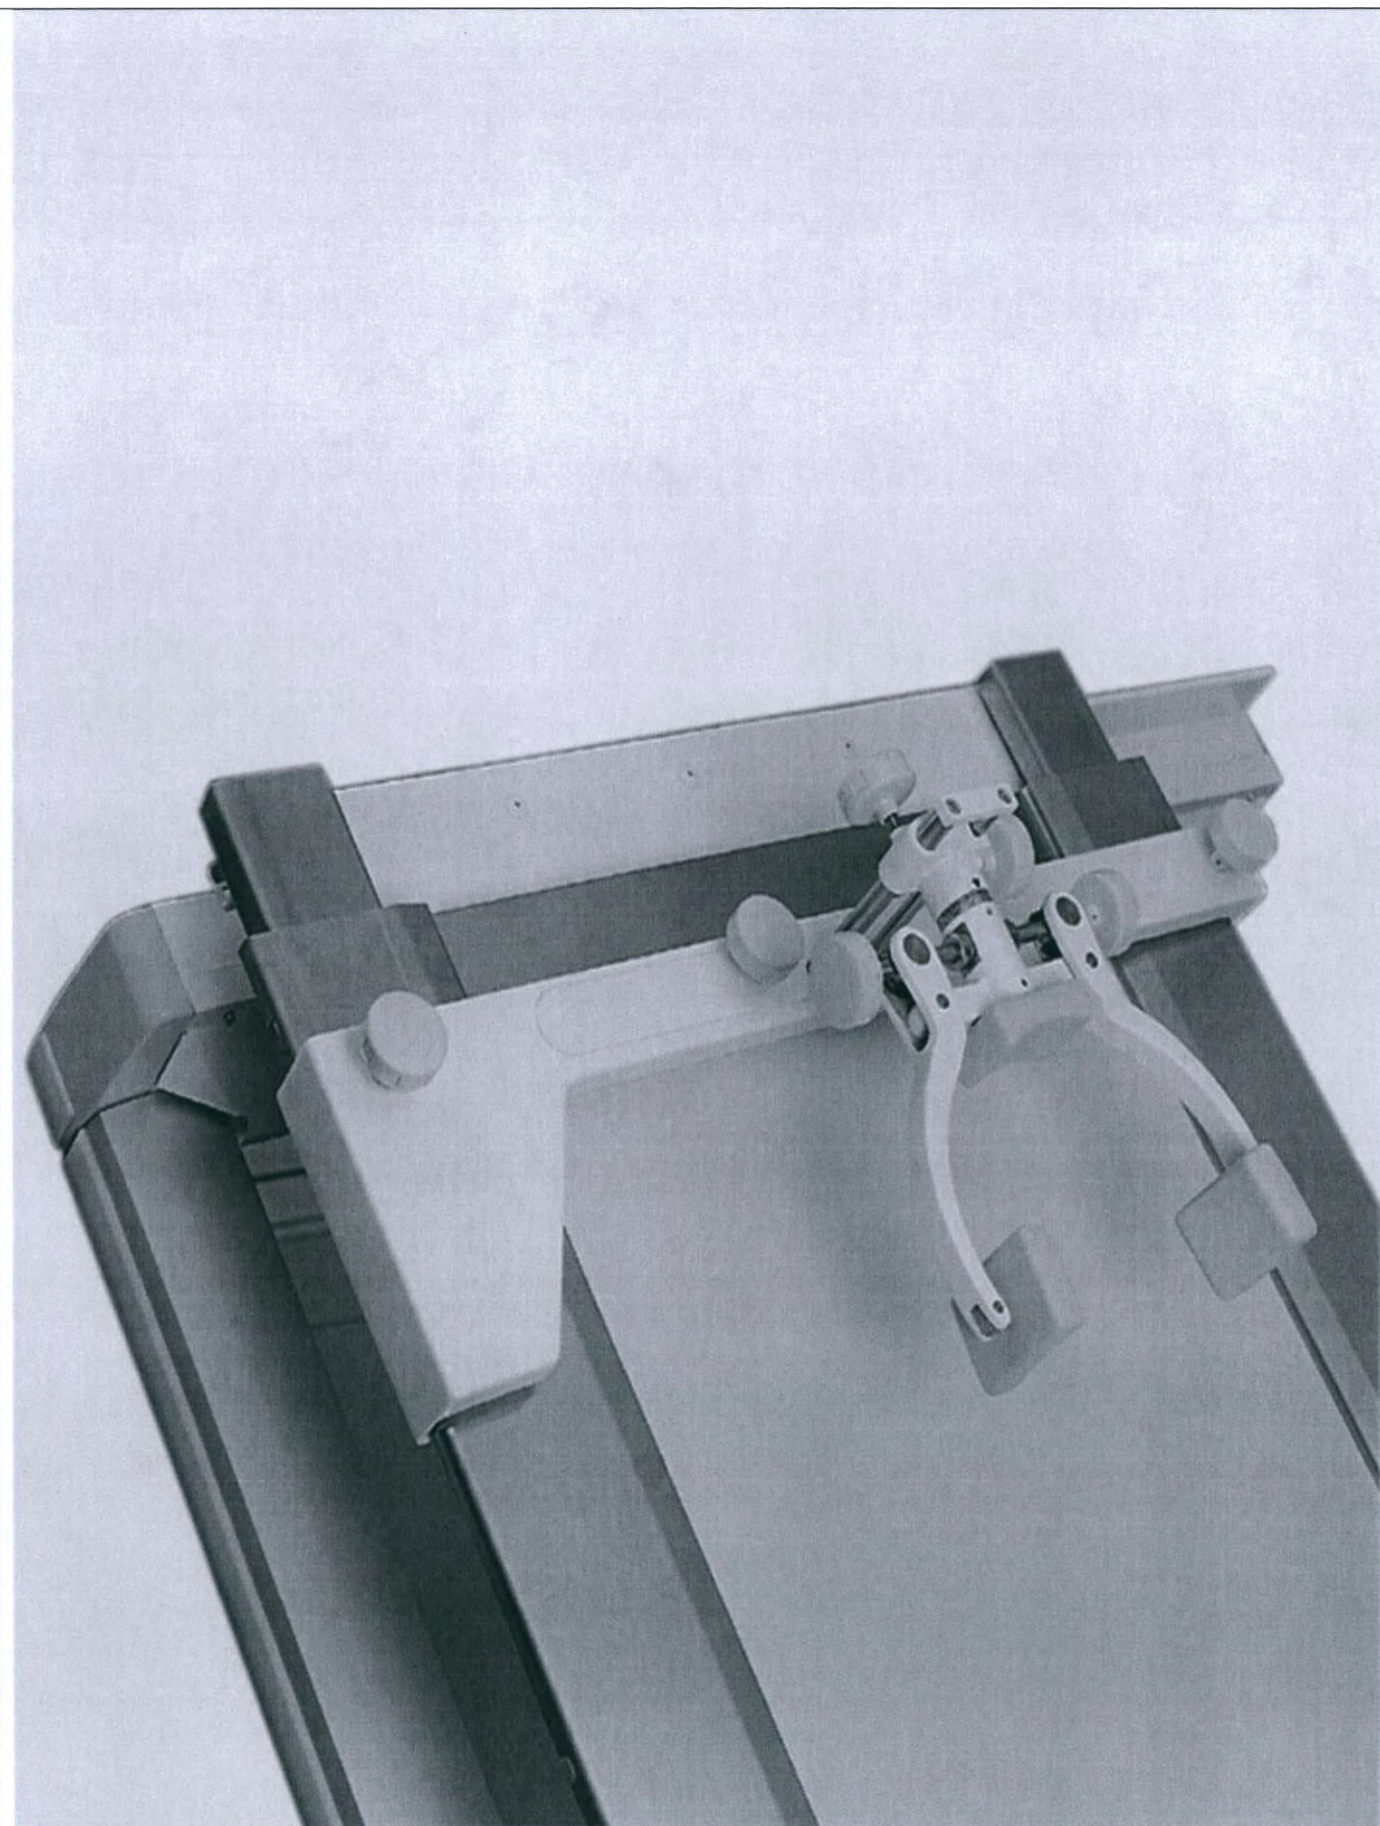


34. Фиксатор для головы.

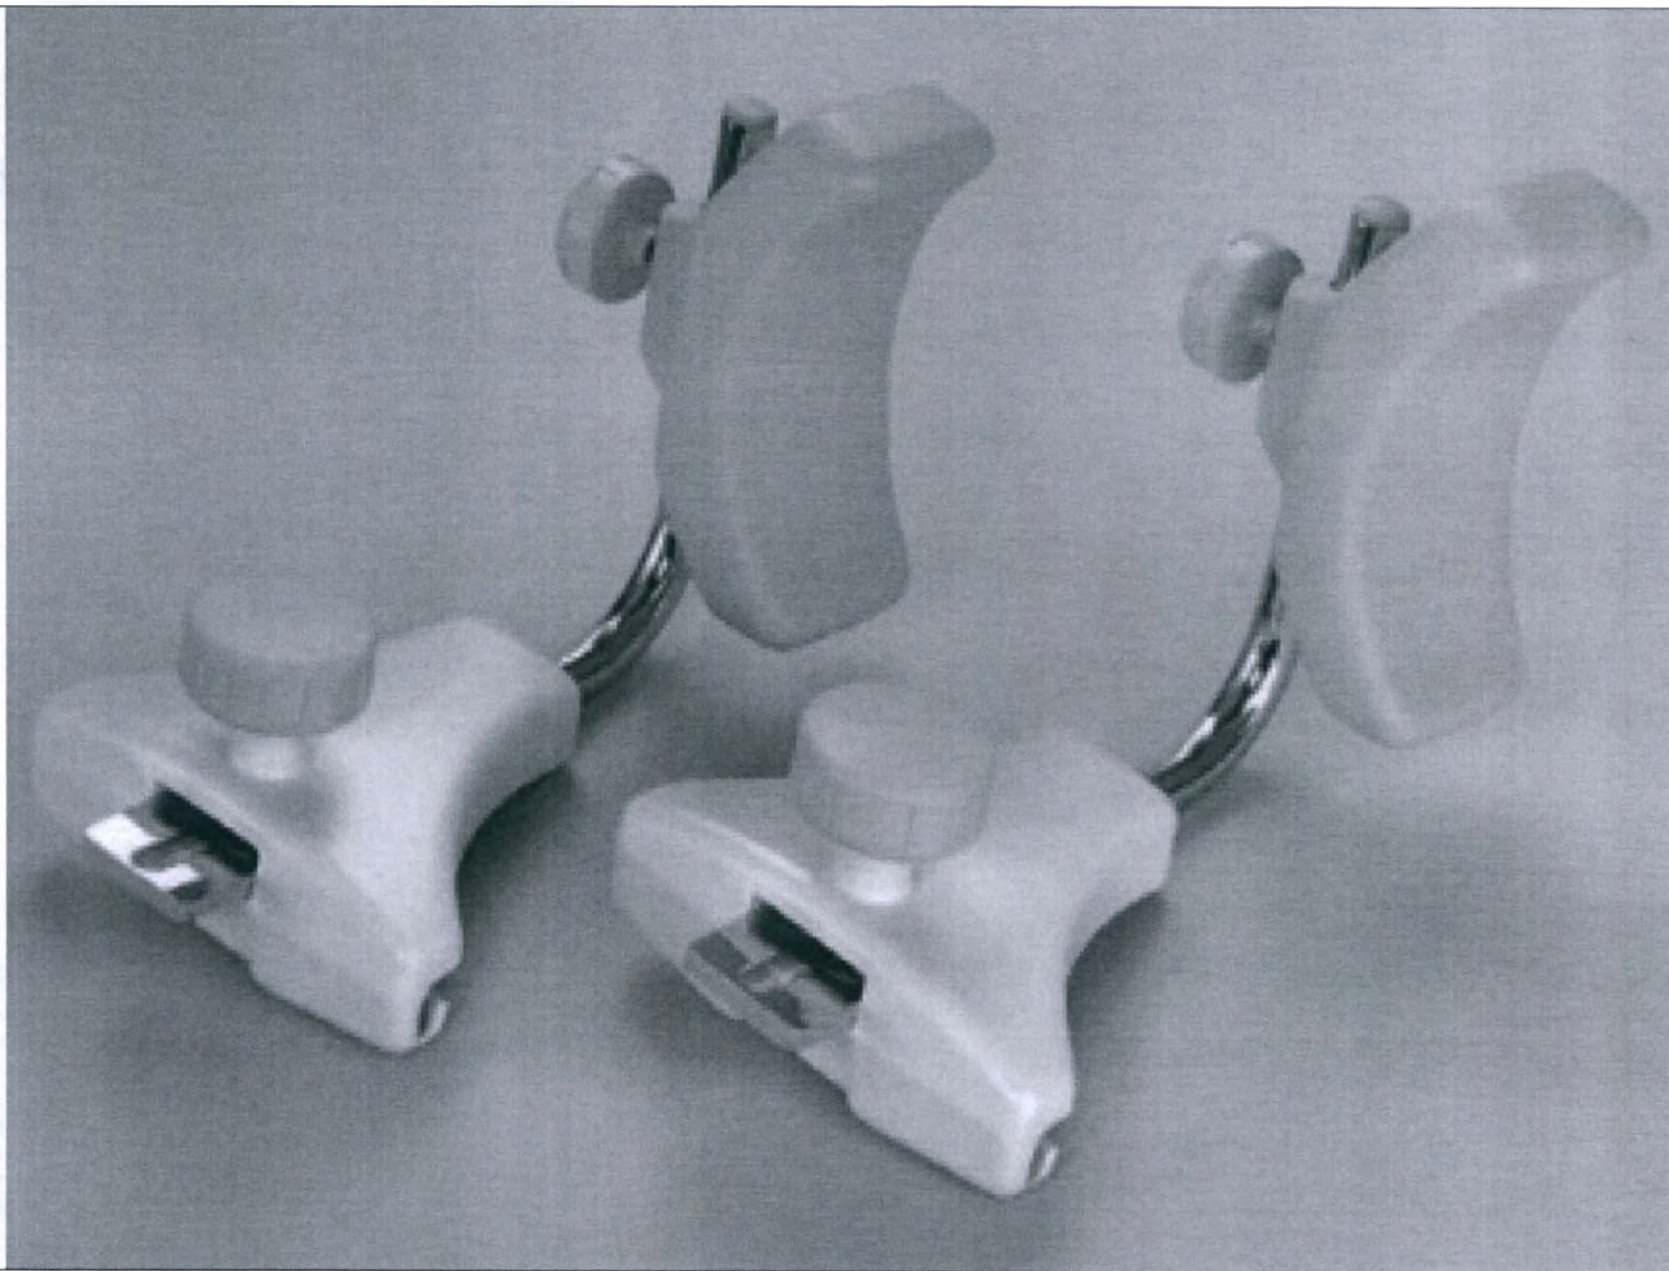


35. Подплечники (пара)




36. Стоподержатель

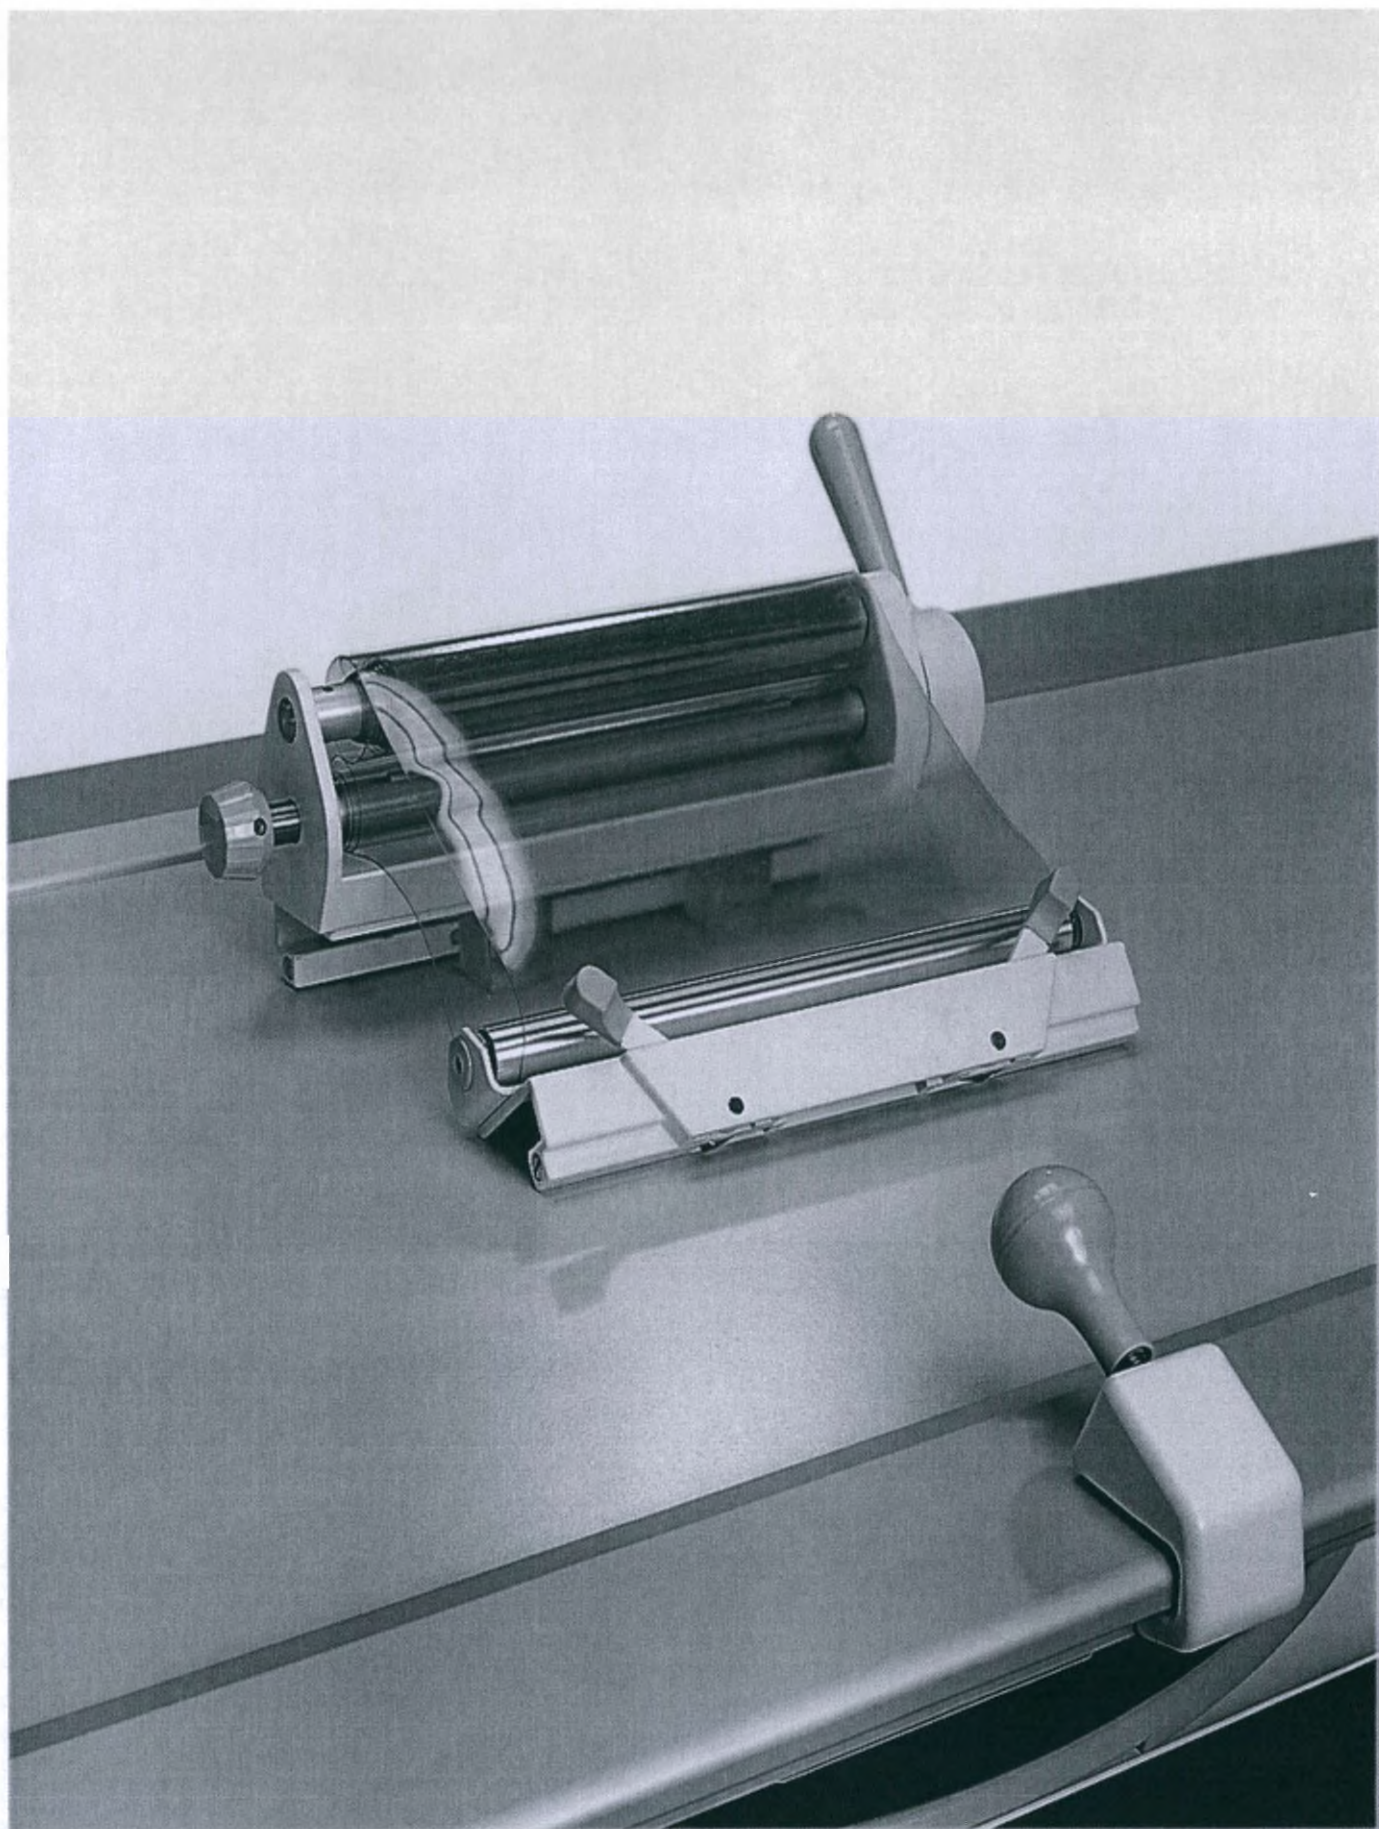


37. Компрессионный ремень.

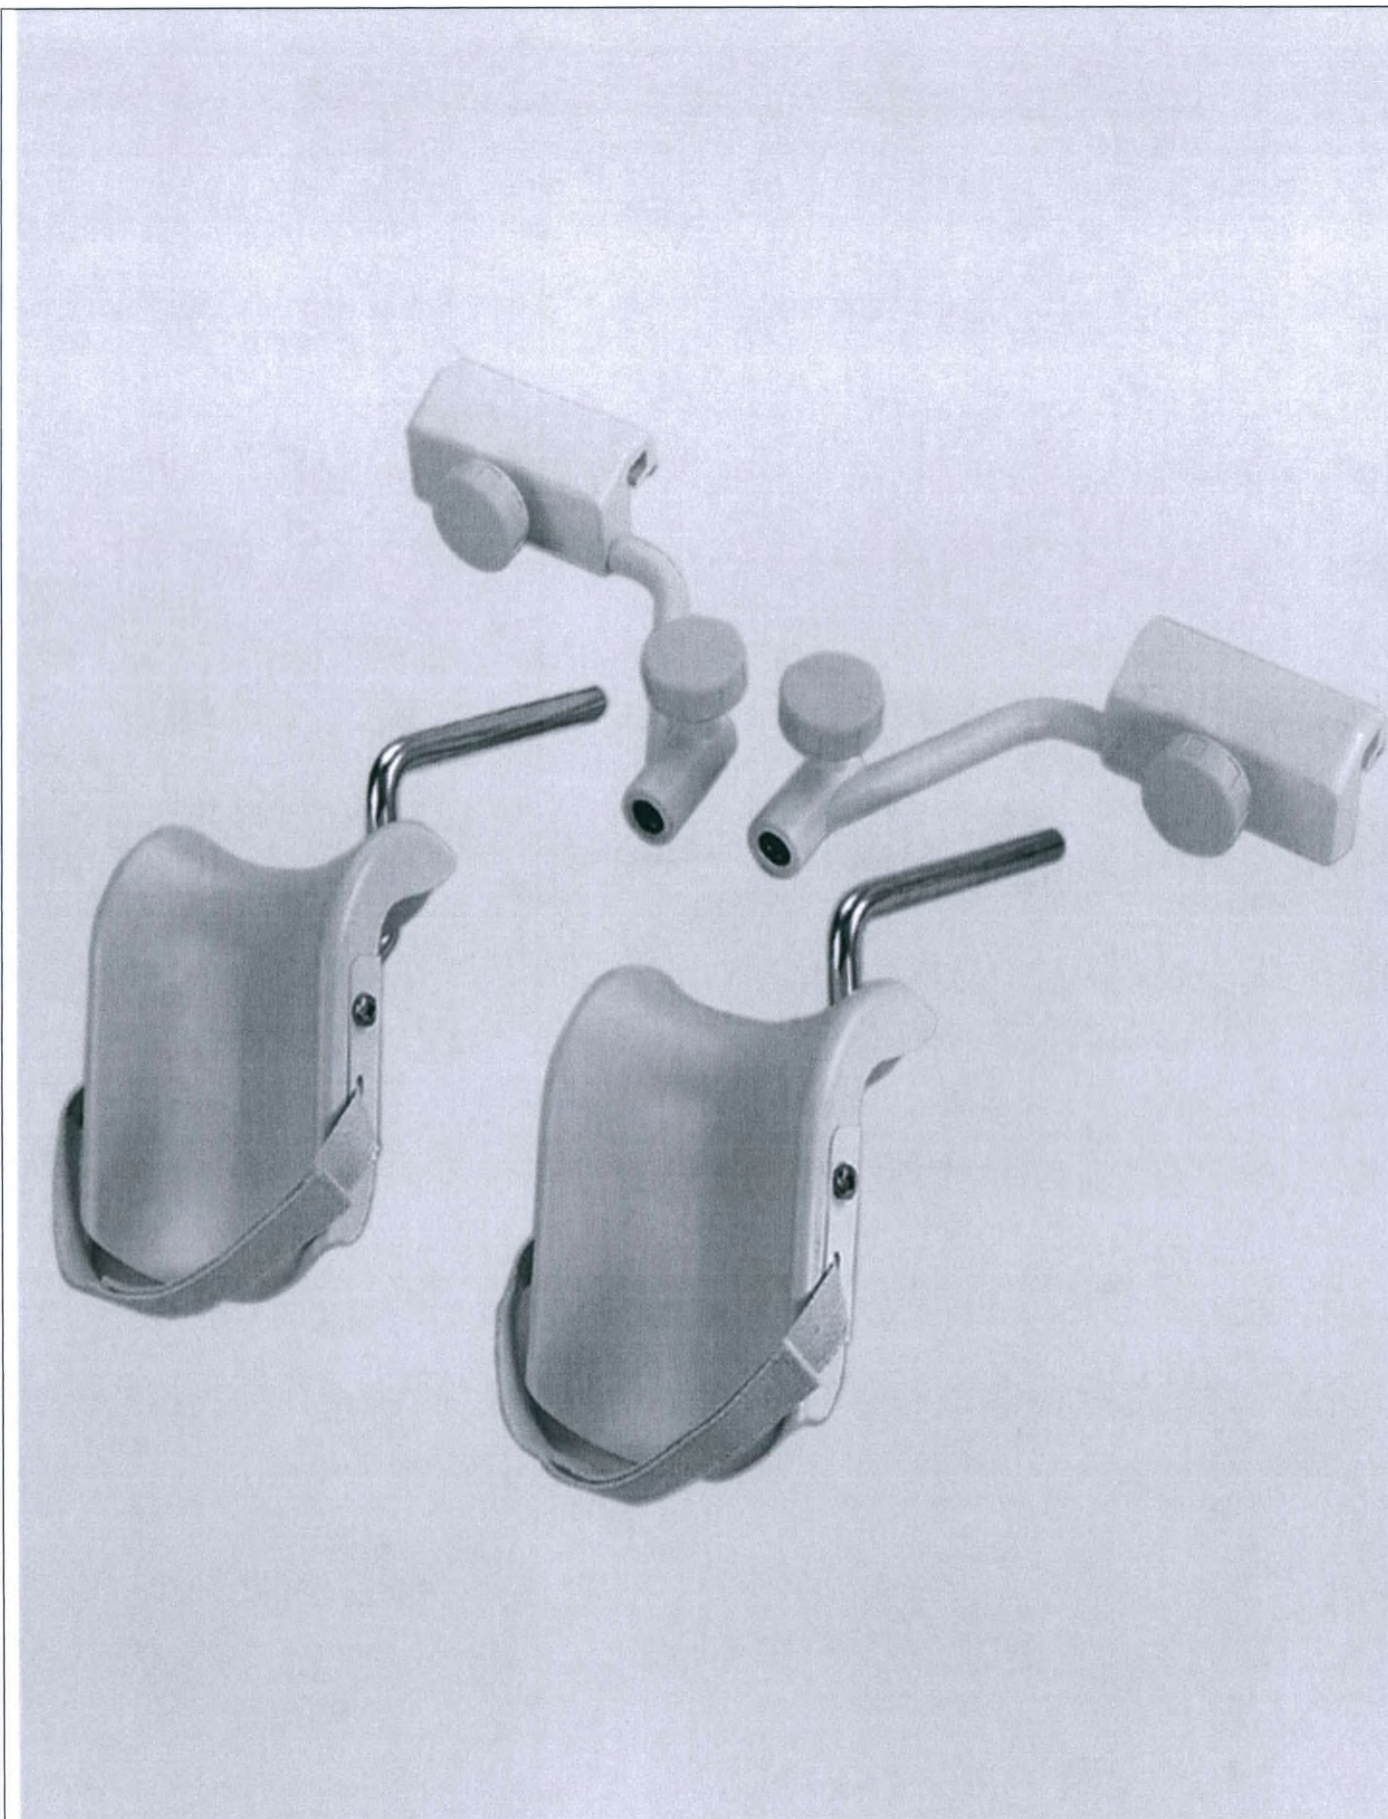


38. Опора для ног (пара).

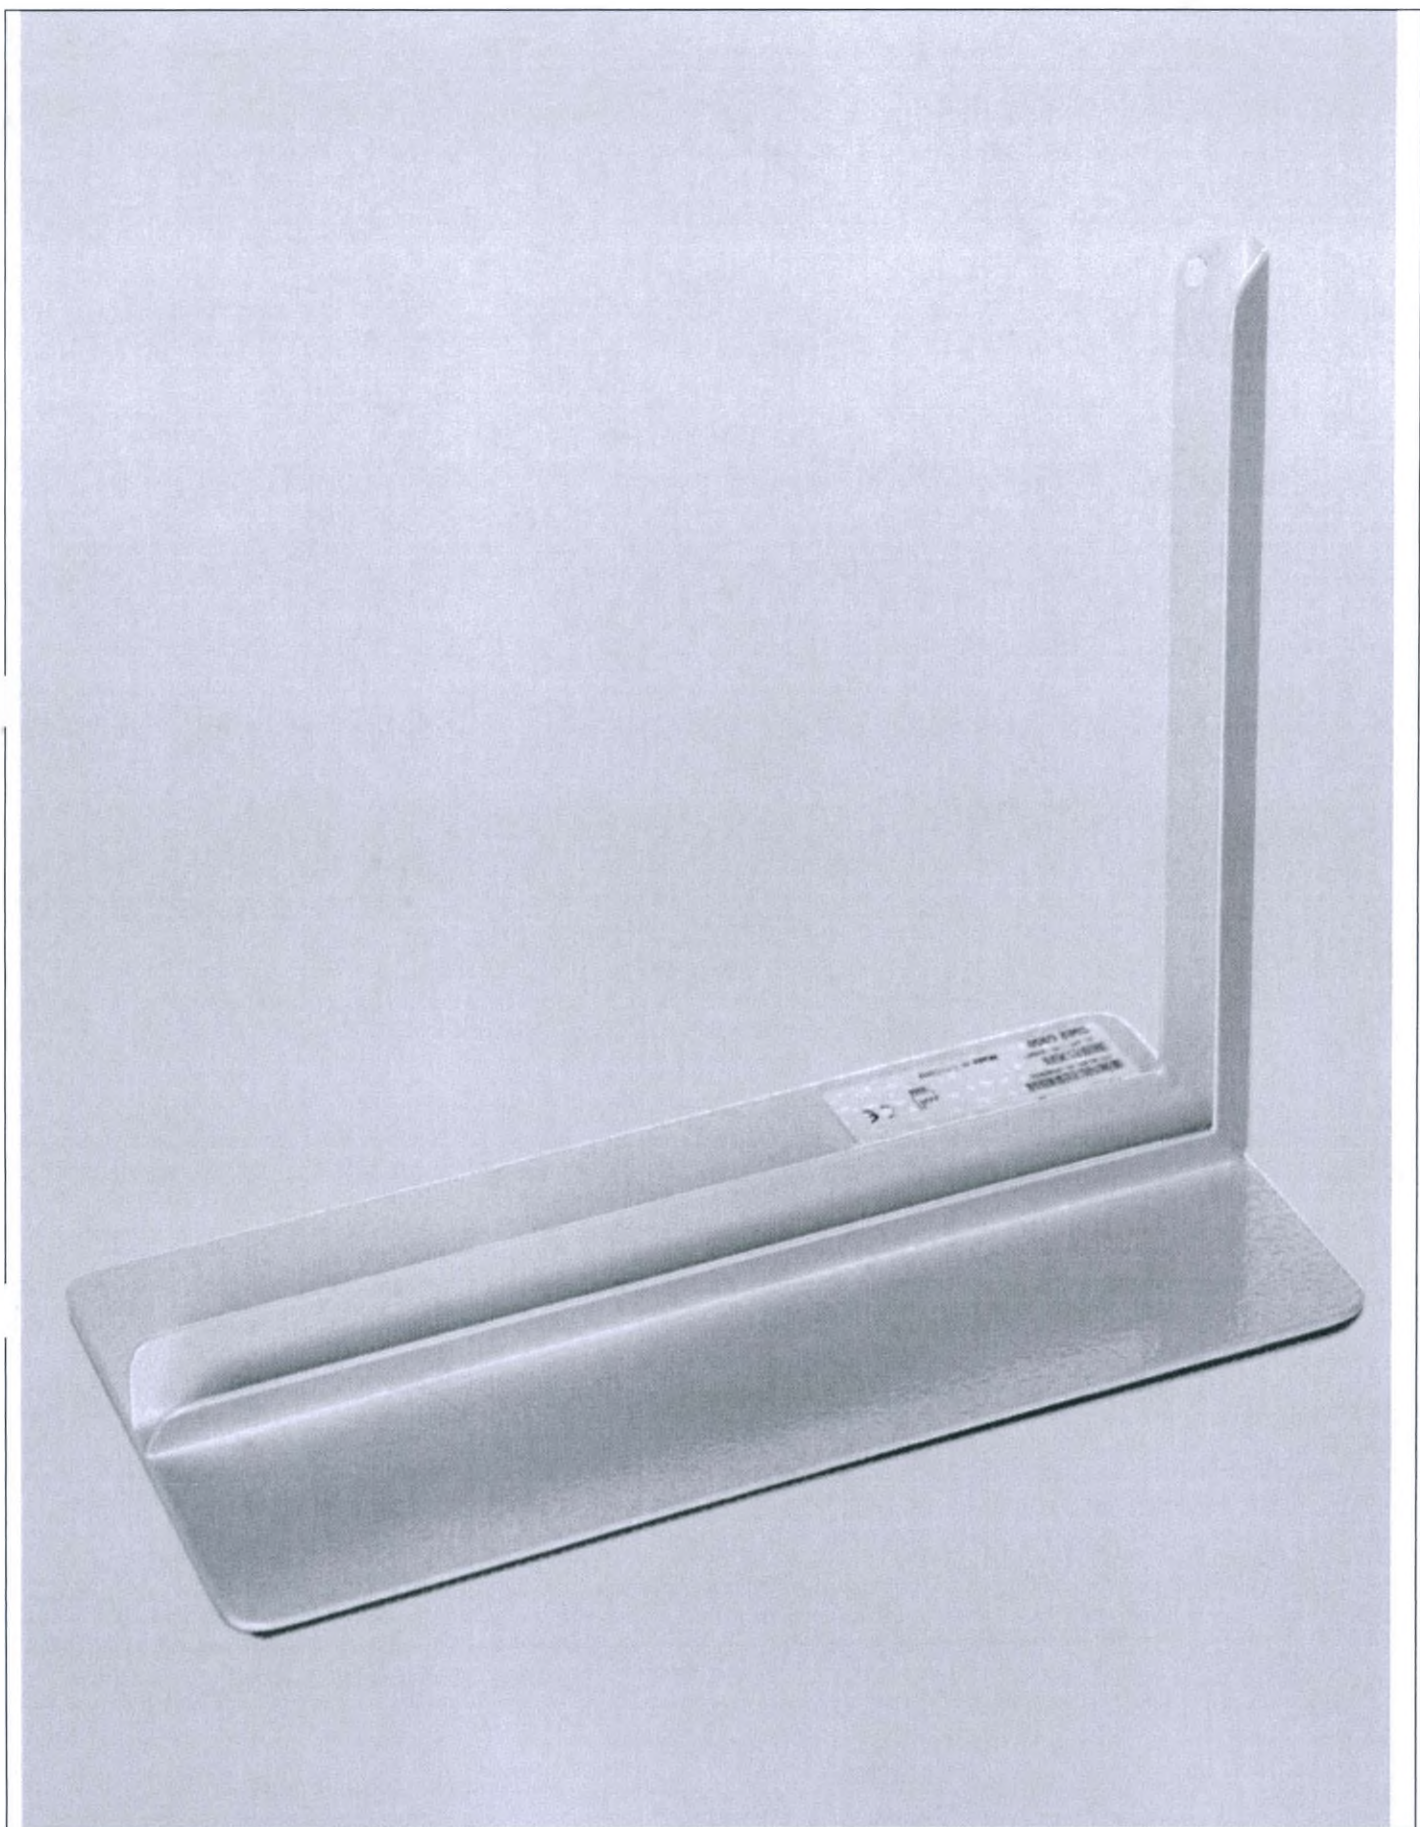


39. Держатель кассеты без фиксатора.

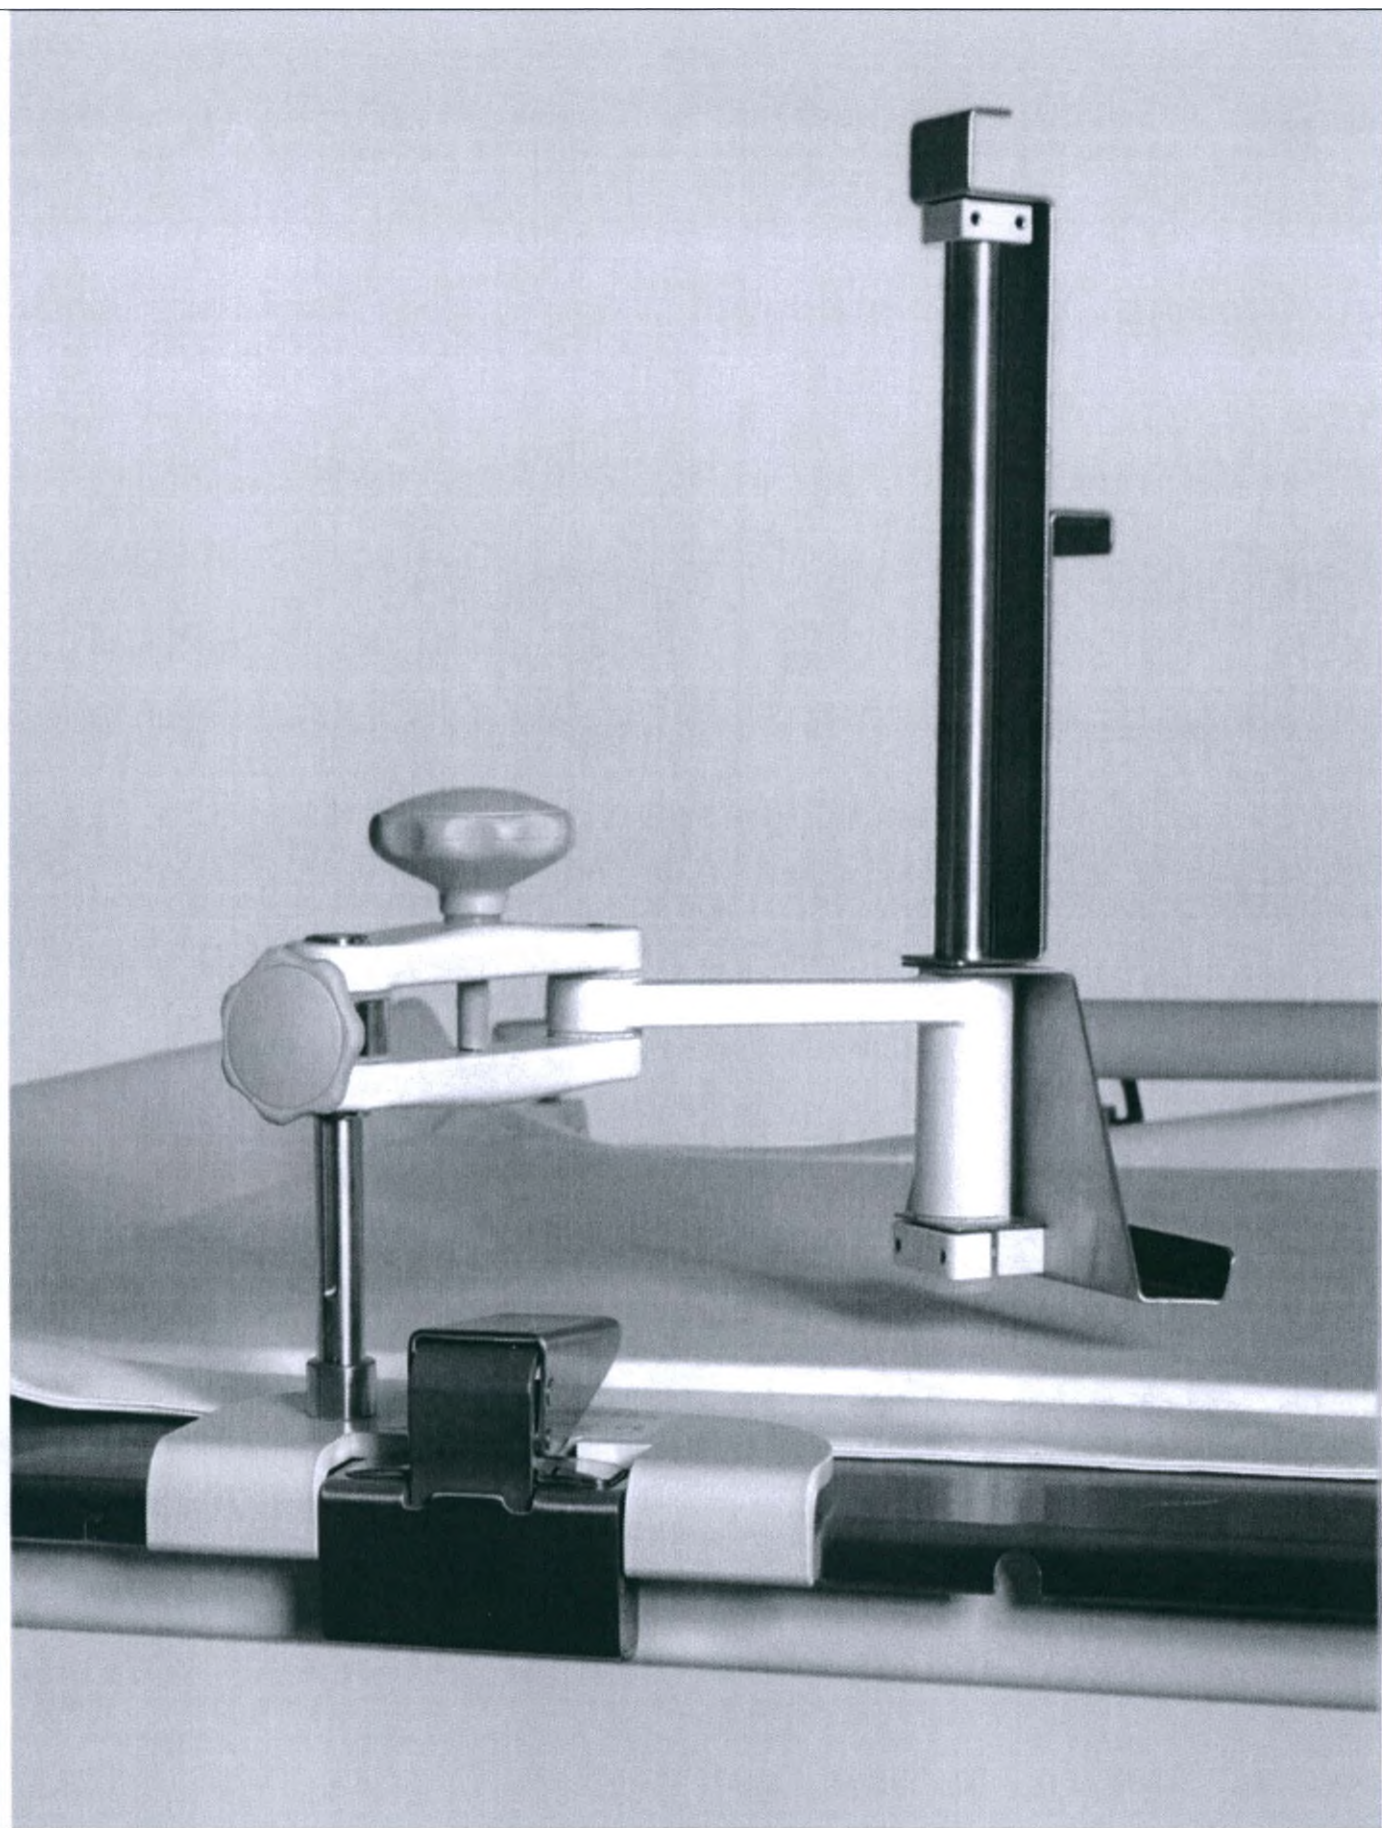


40. Боковой кассетодержатель.

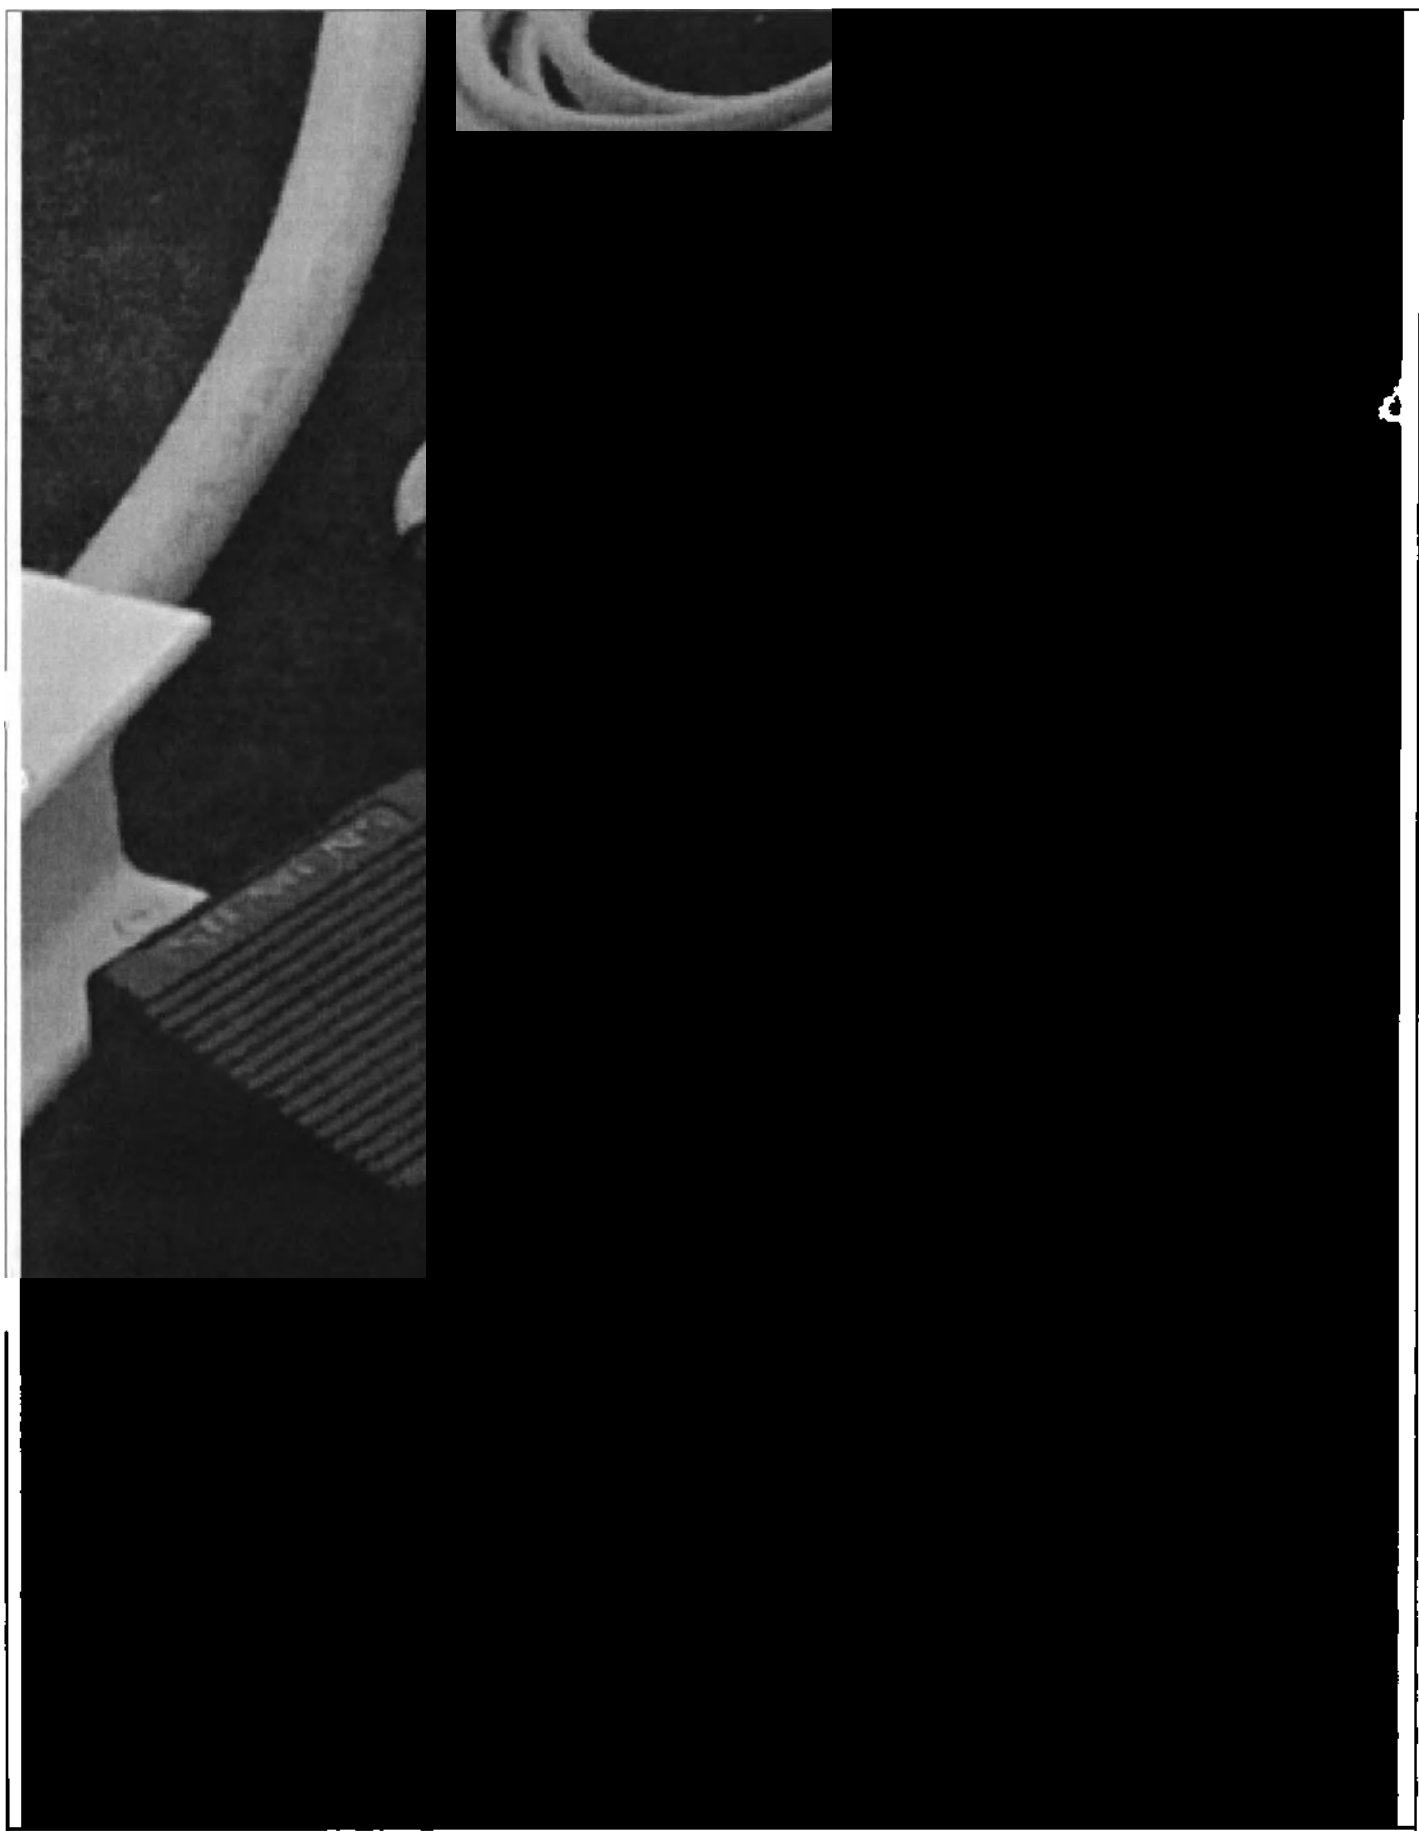


41. Педальный переключатель для экспонирования (рентгеноскопия и рентгенография).

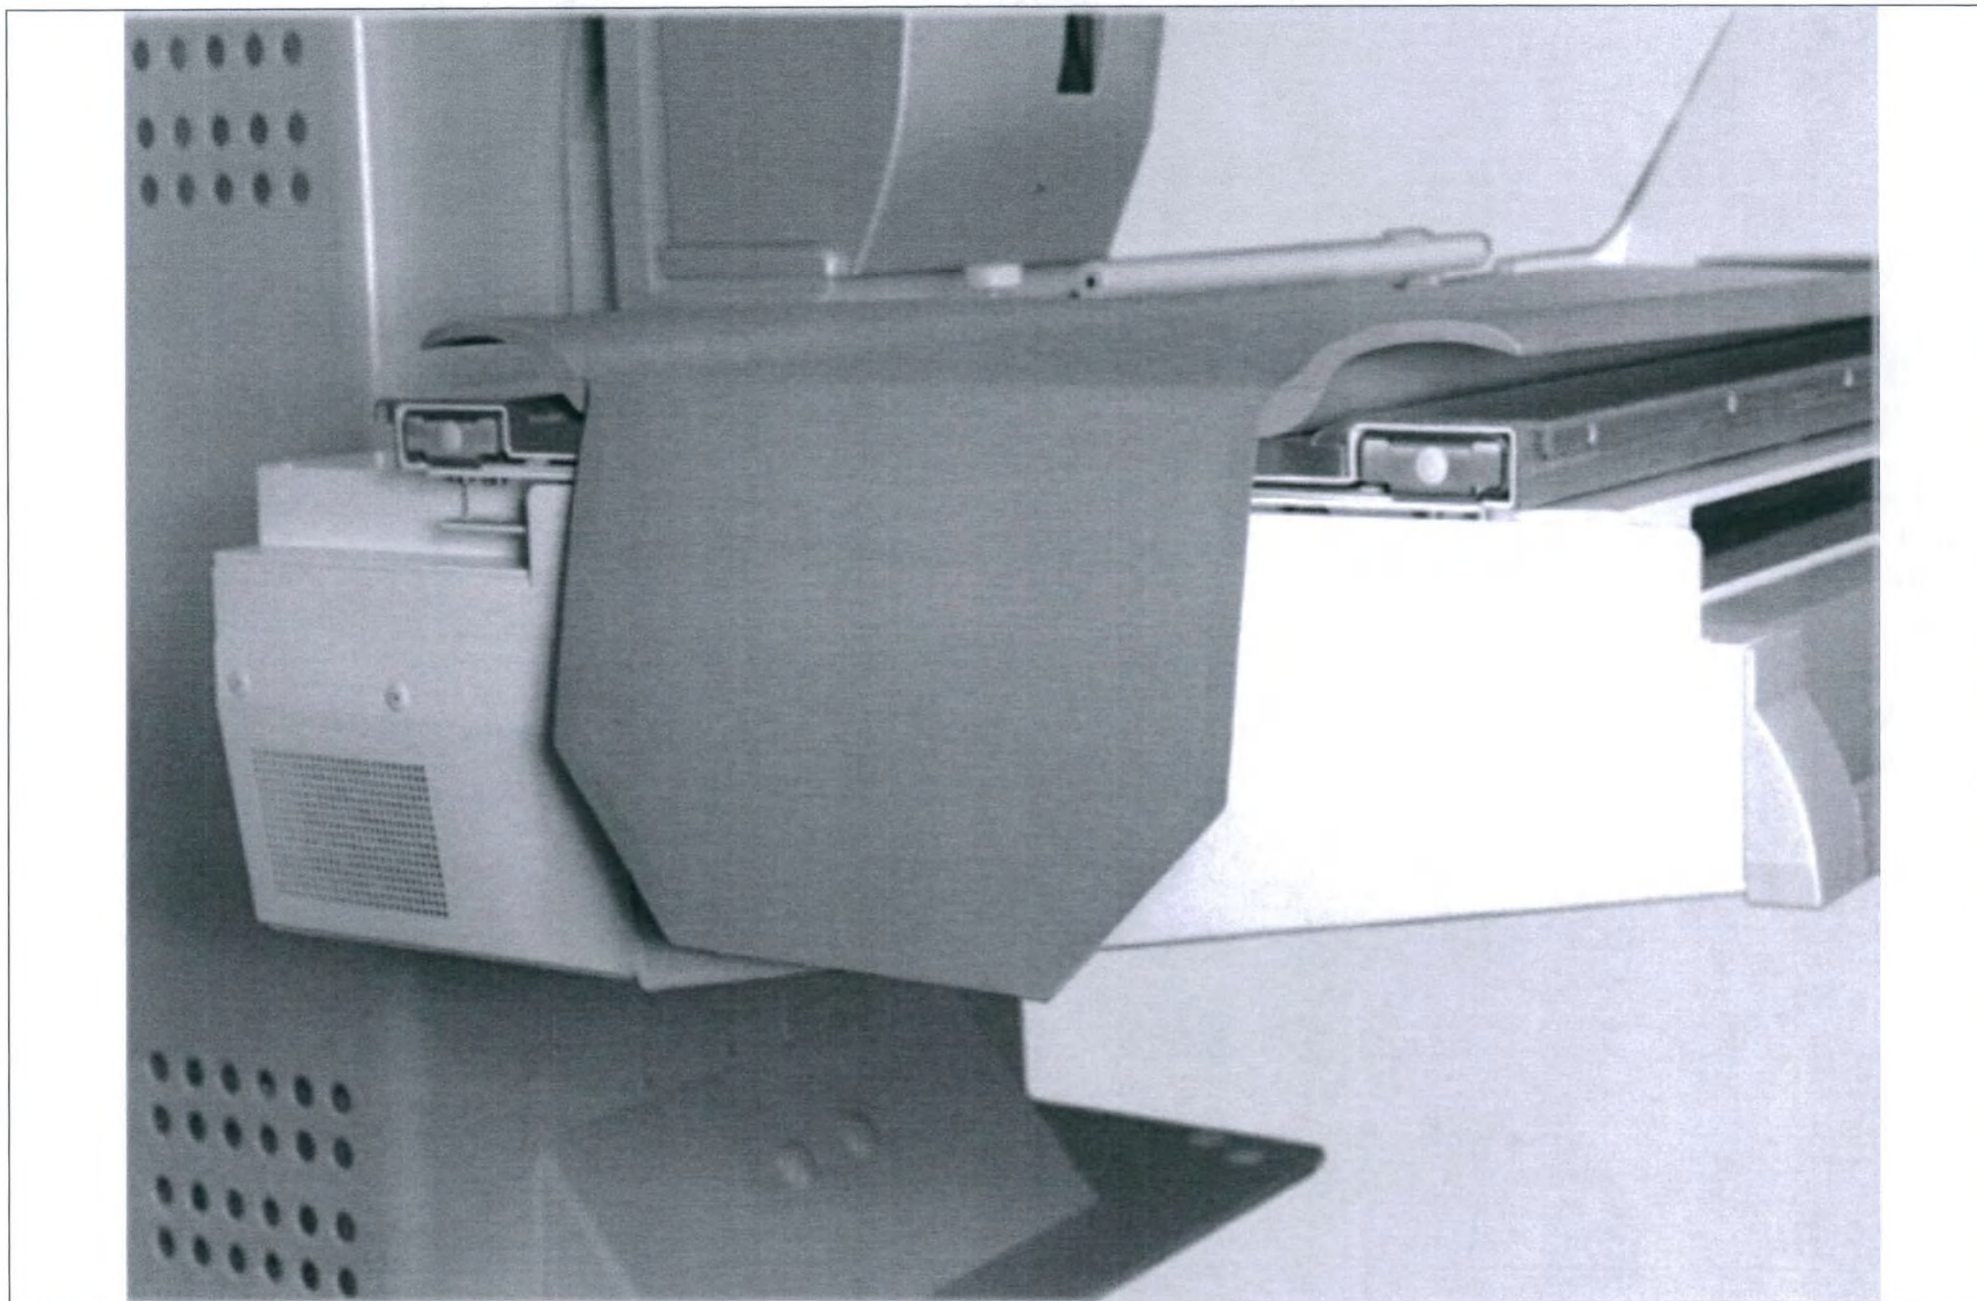

42. Матрац для позиционирования пациента.

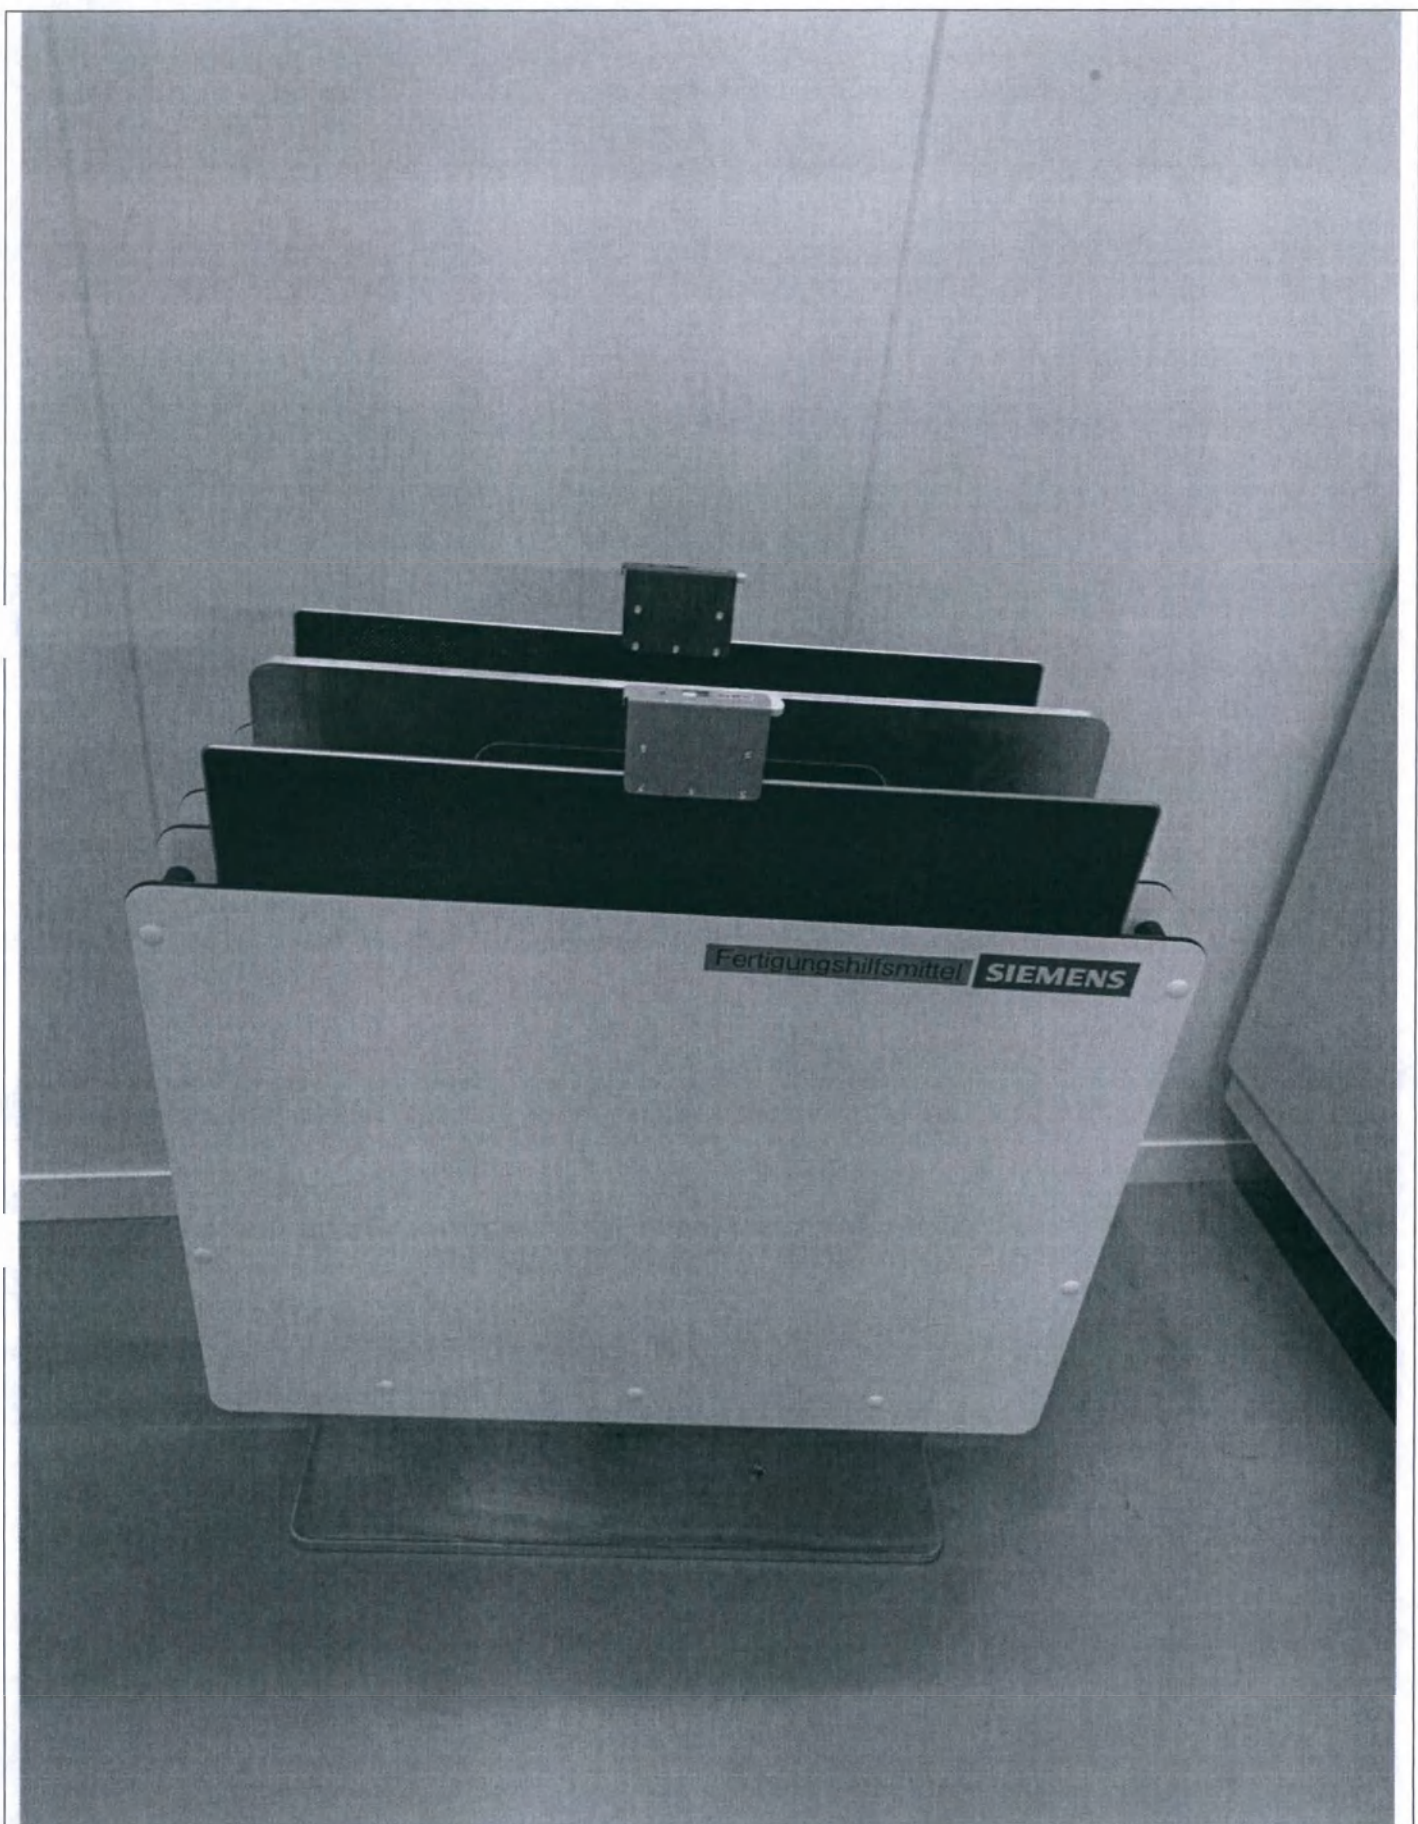


43. Настенный держатель для решеток.

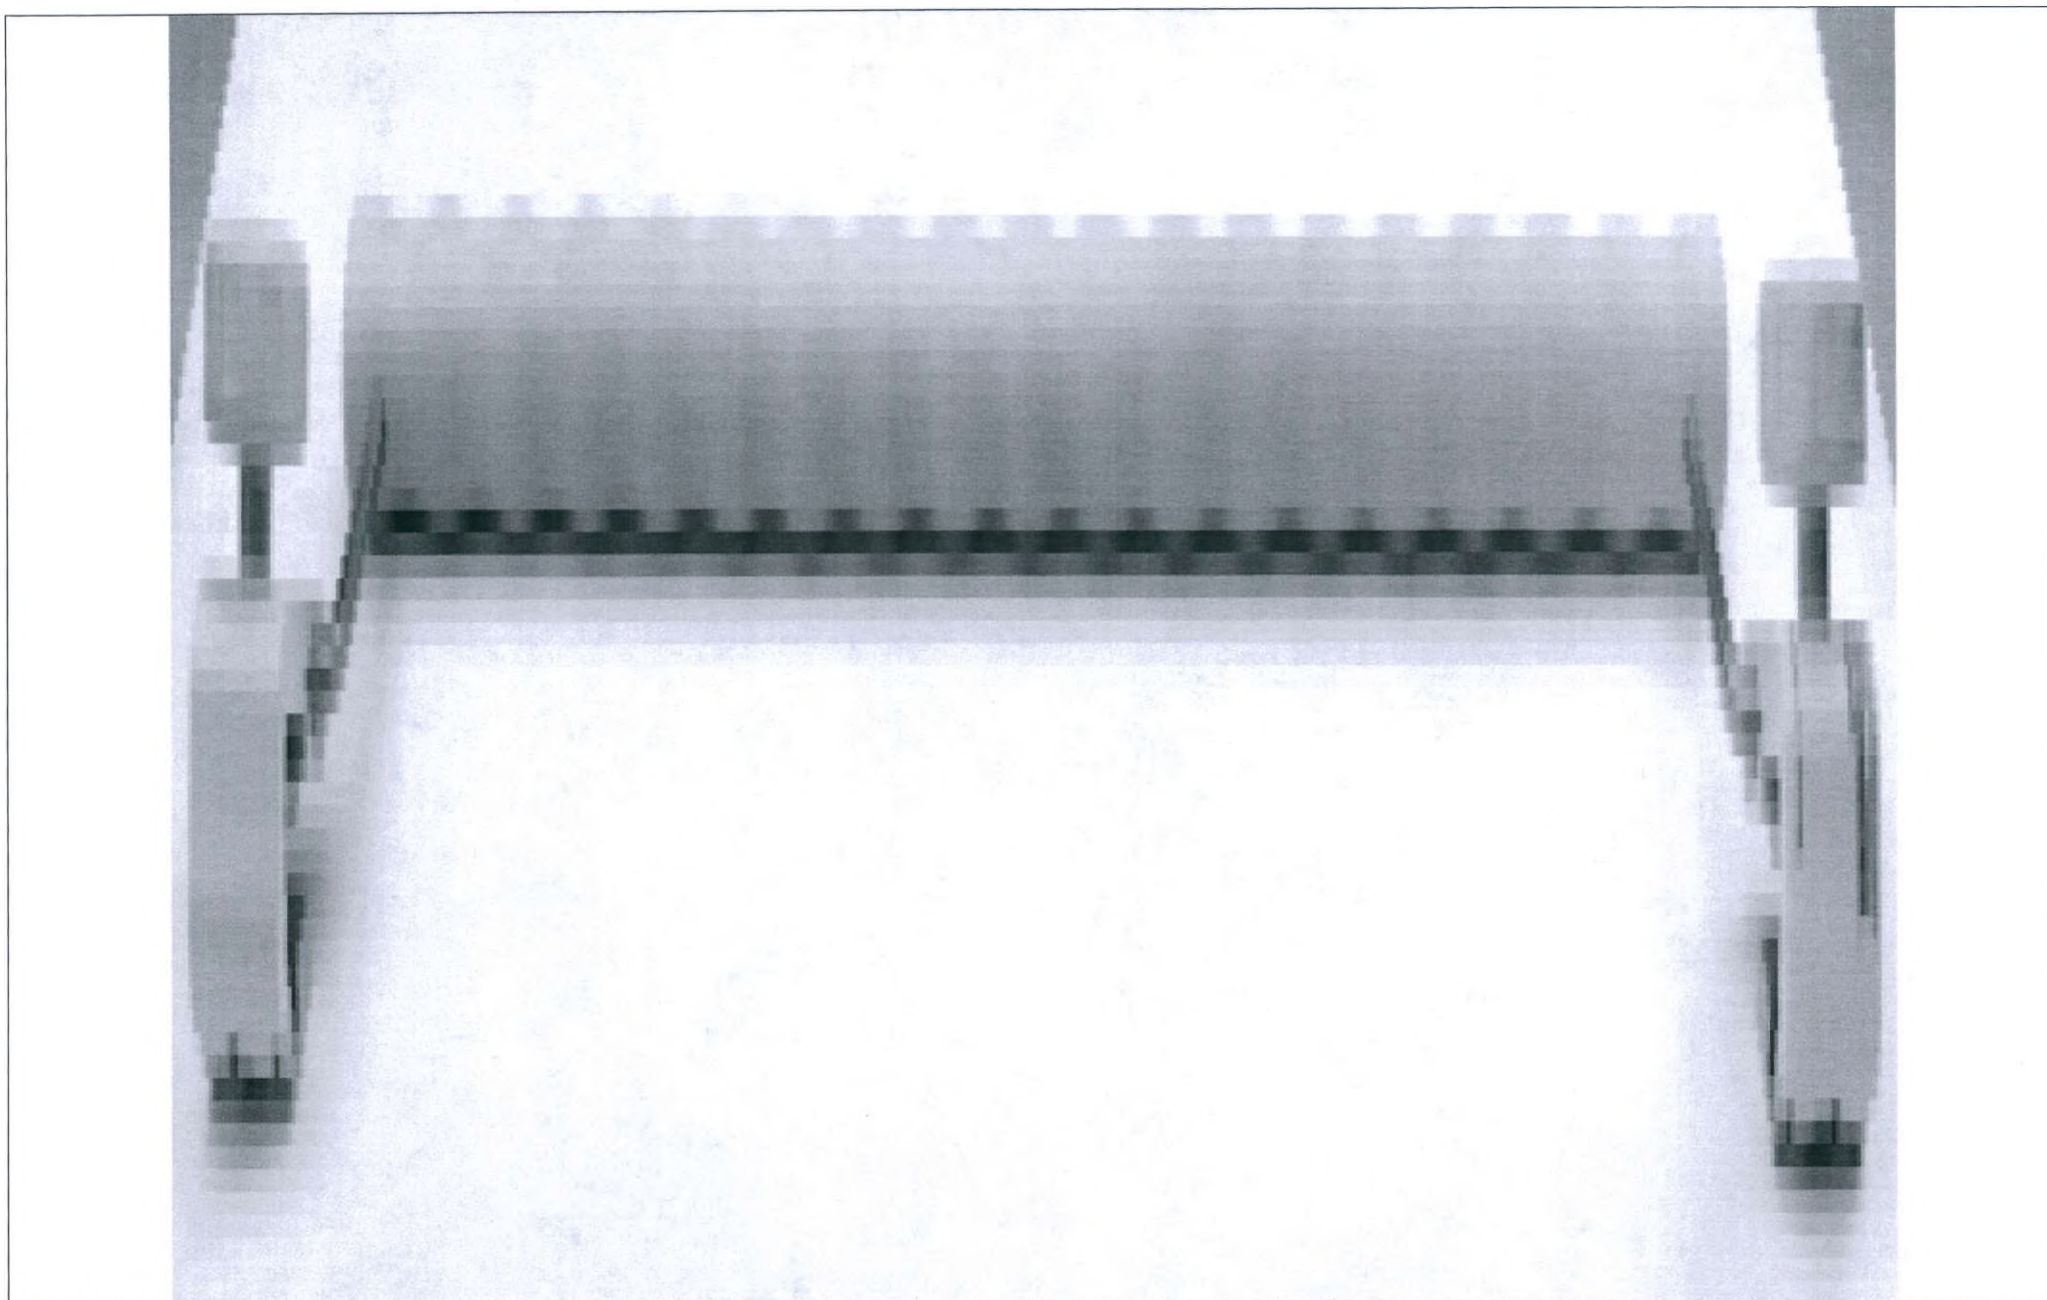

44. Планка-поручень




45. Опорная ручка

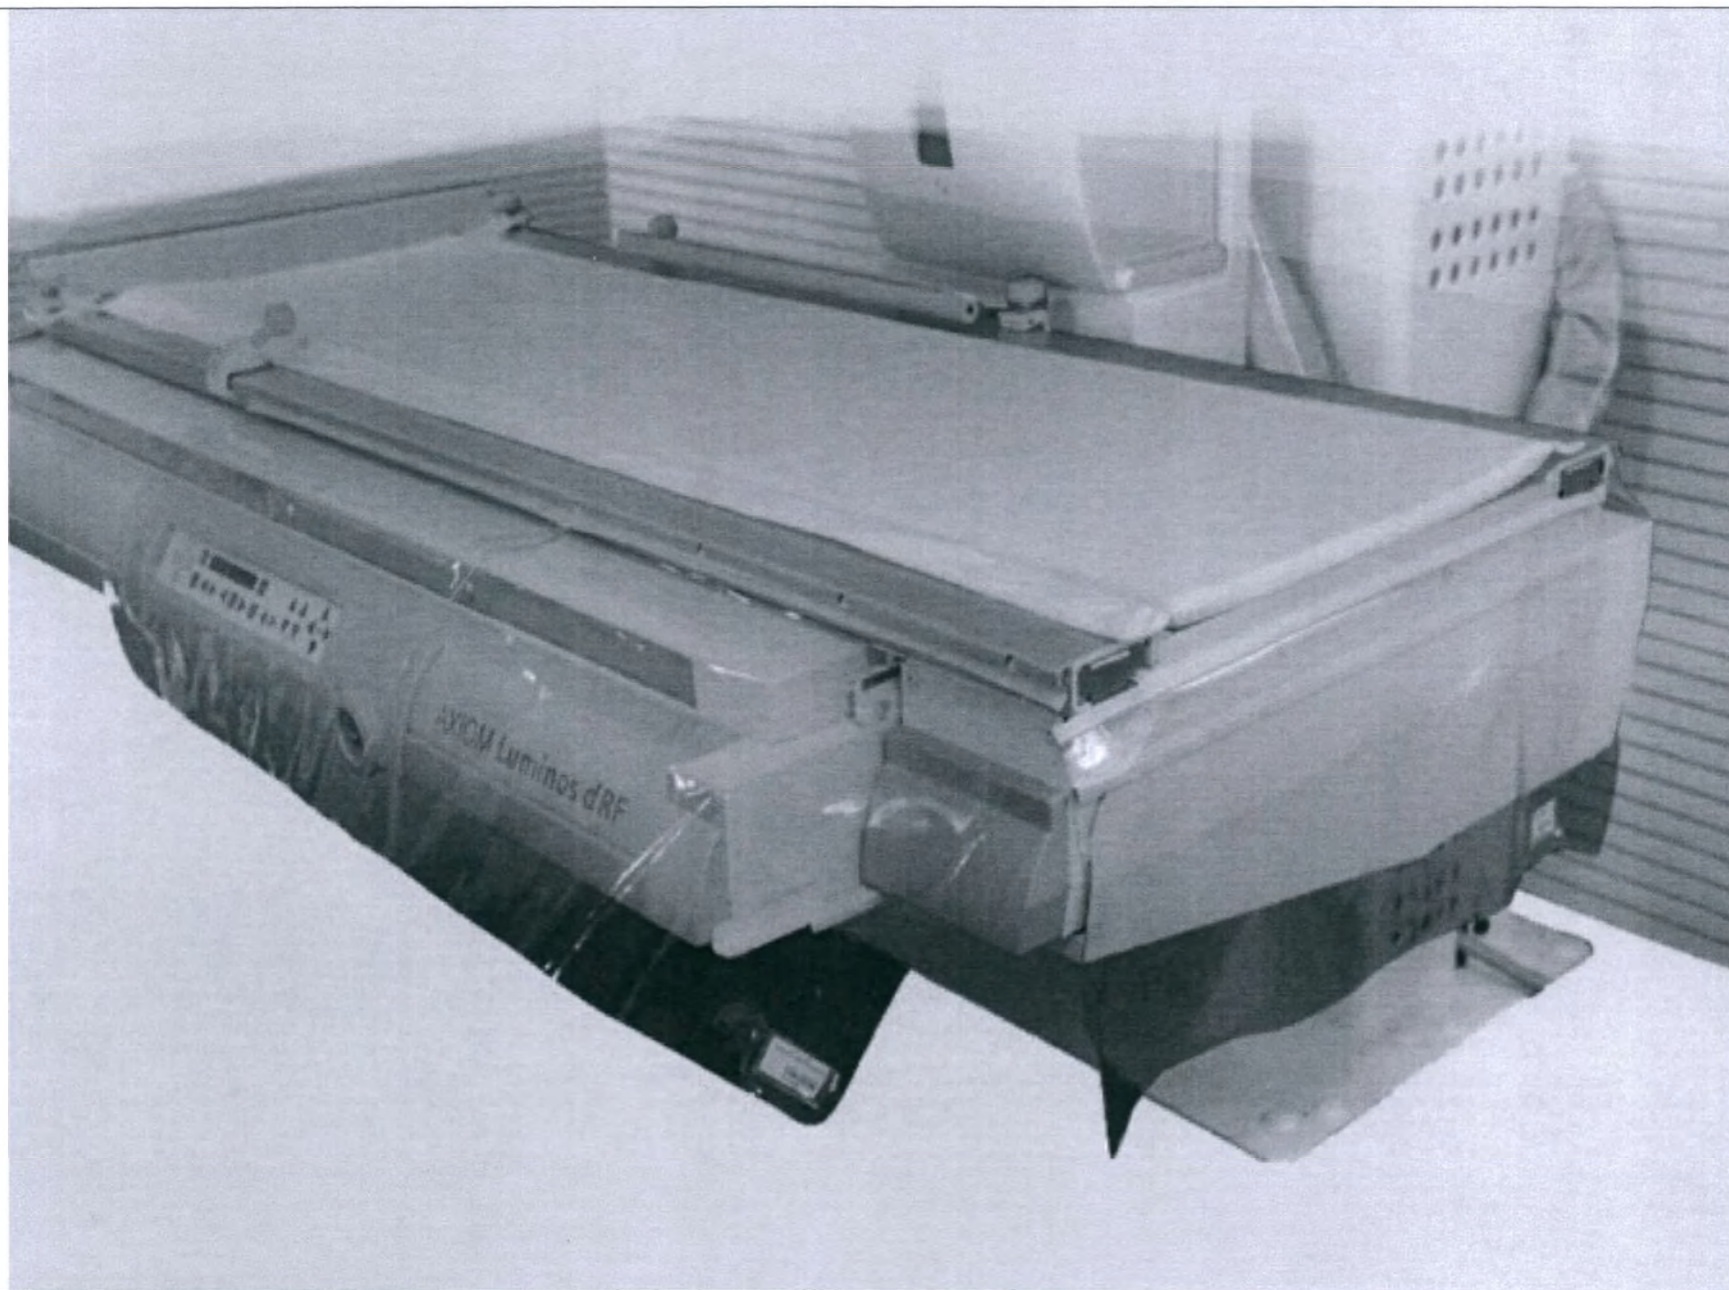


46. Средства защиты от попадания жидкостей




47. Стойка Ortho многофункциональная

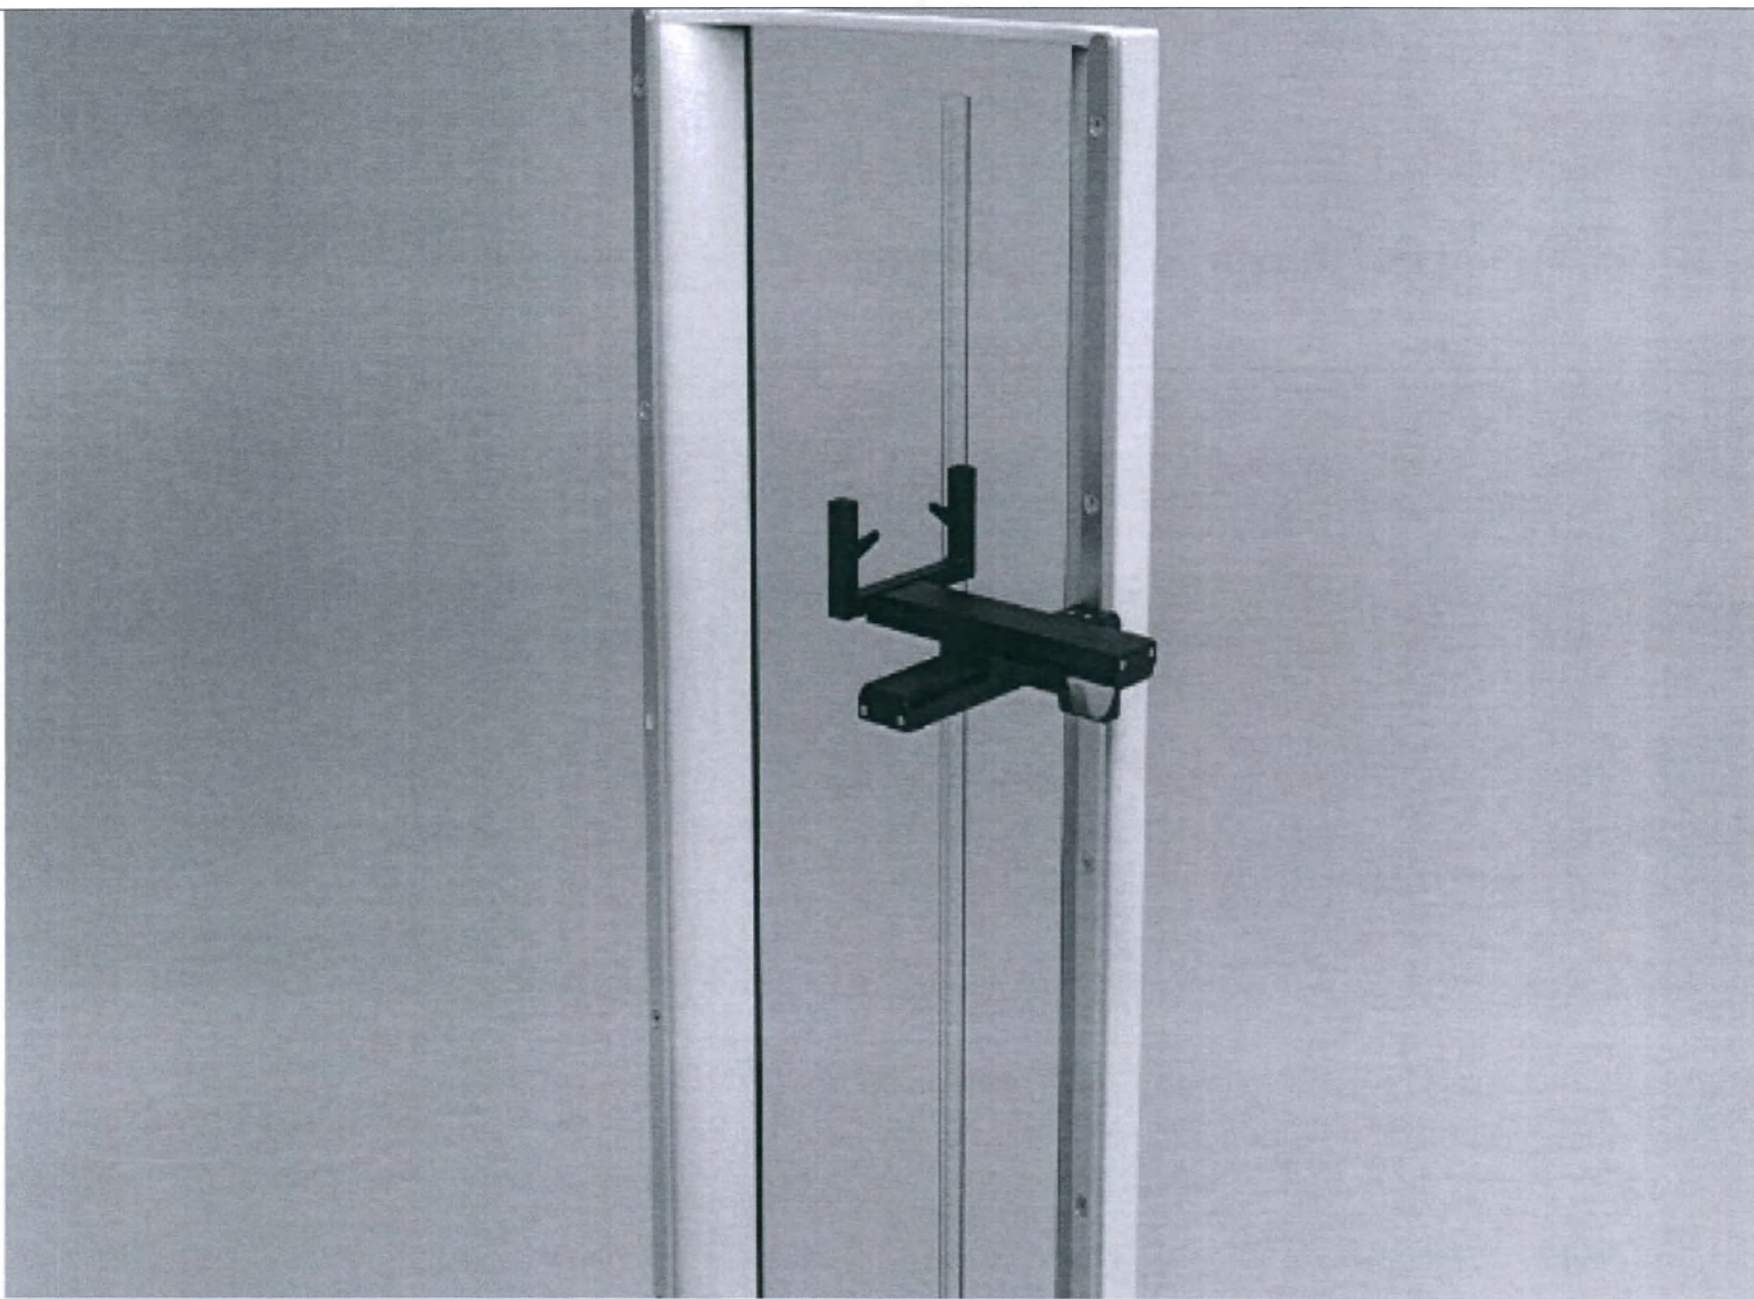


48. Линейка с держателем для стойки Ortho

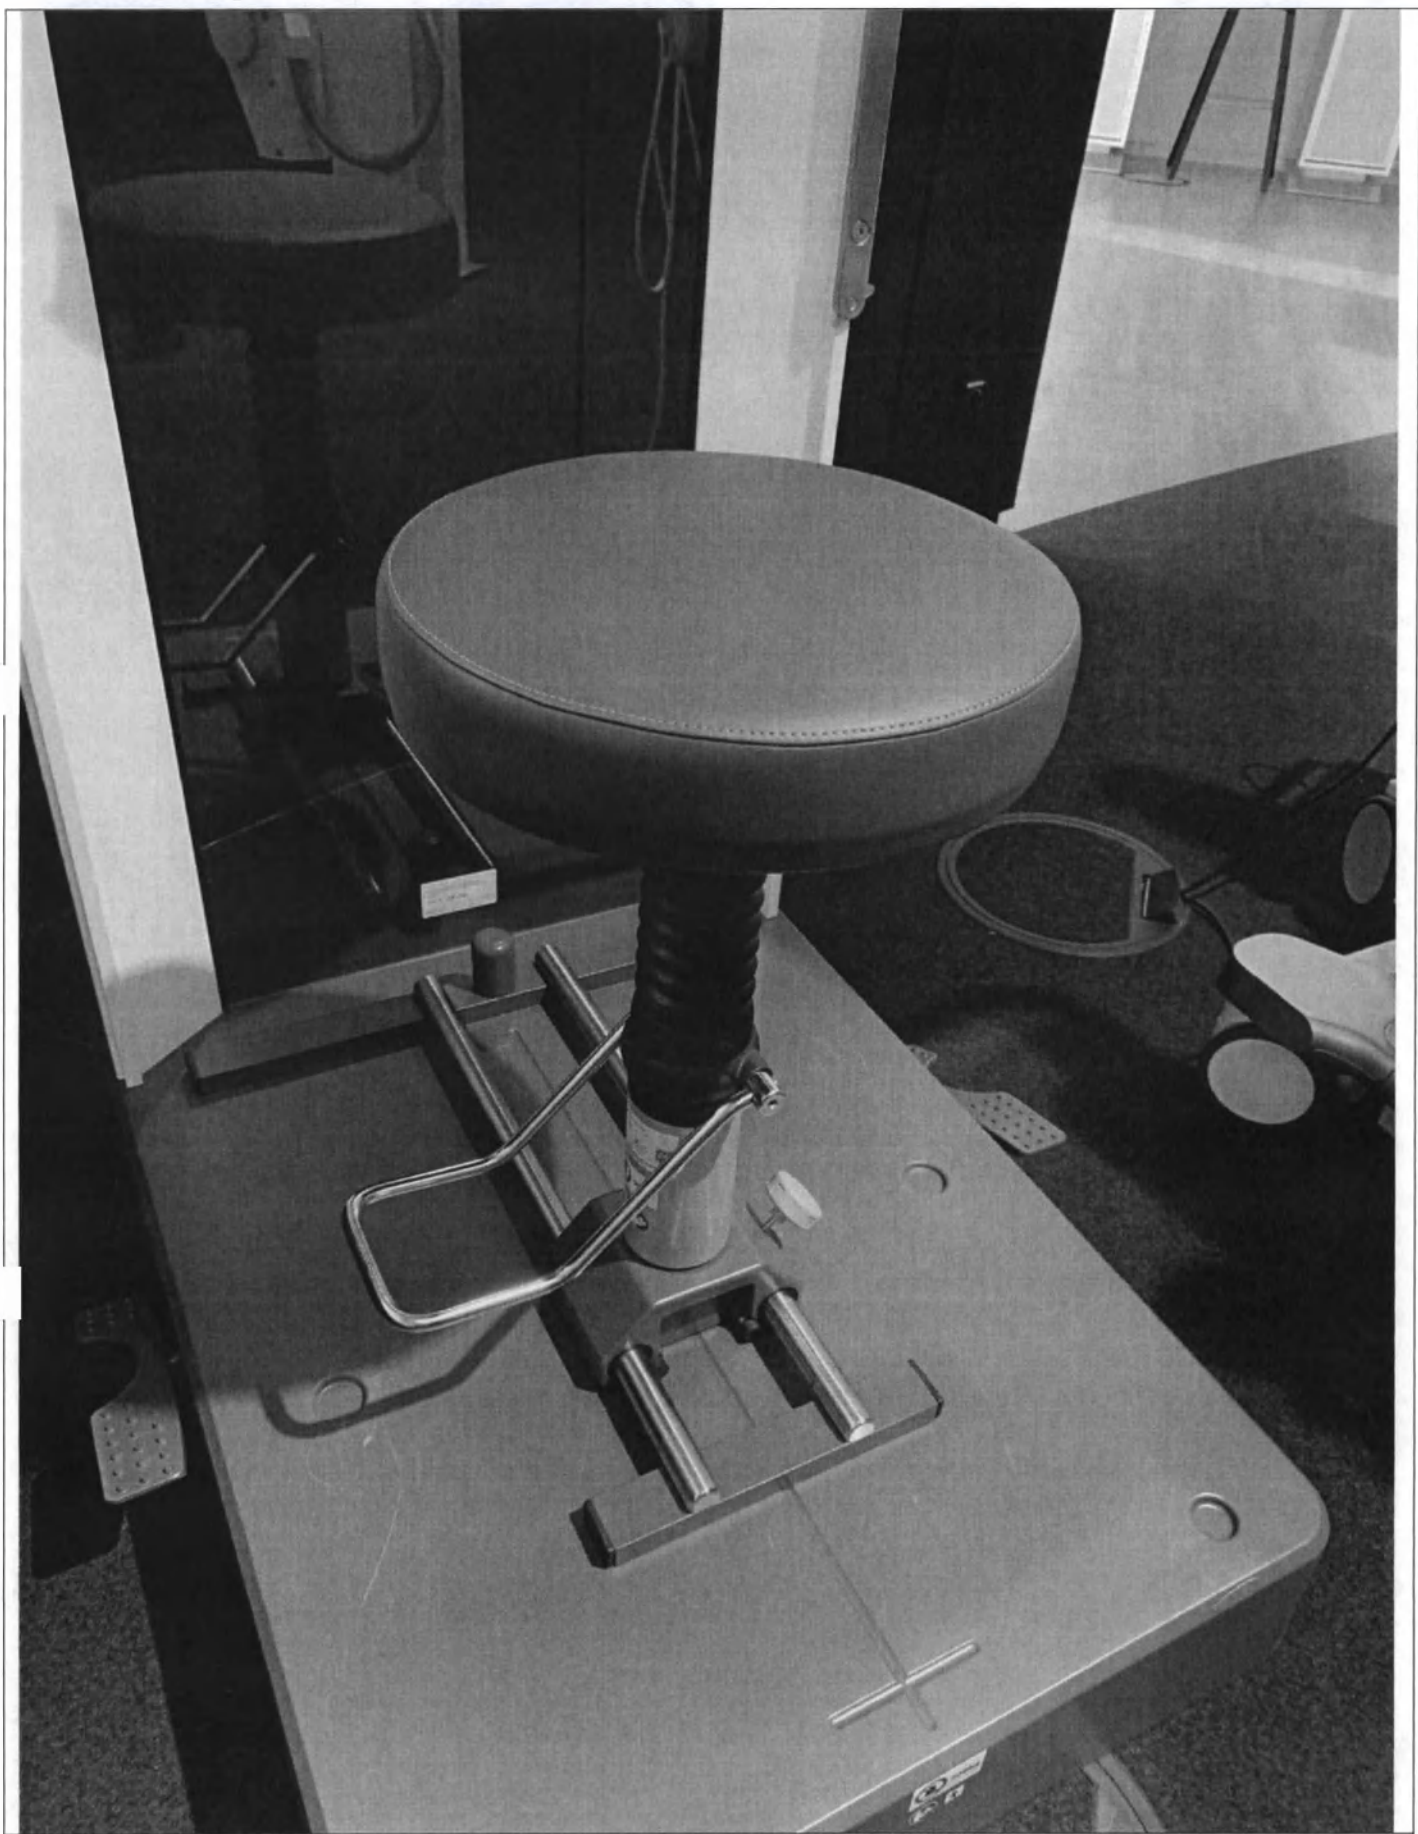


49. Вращающийся стул.

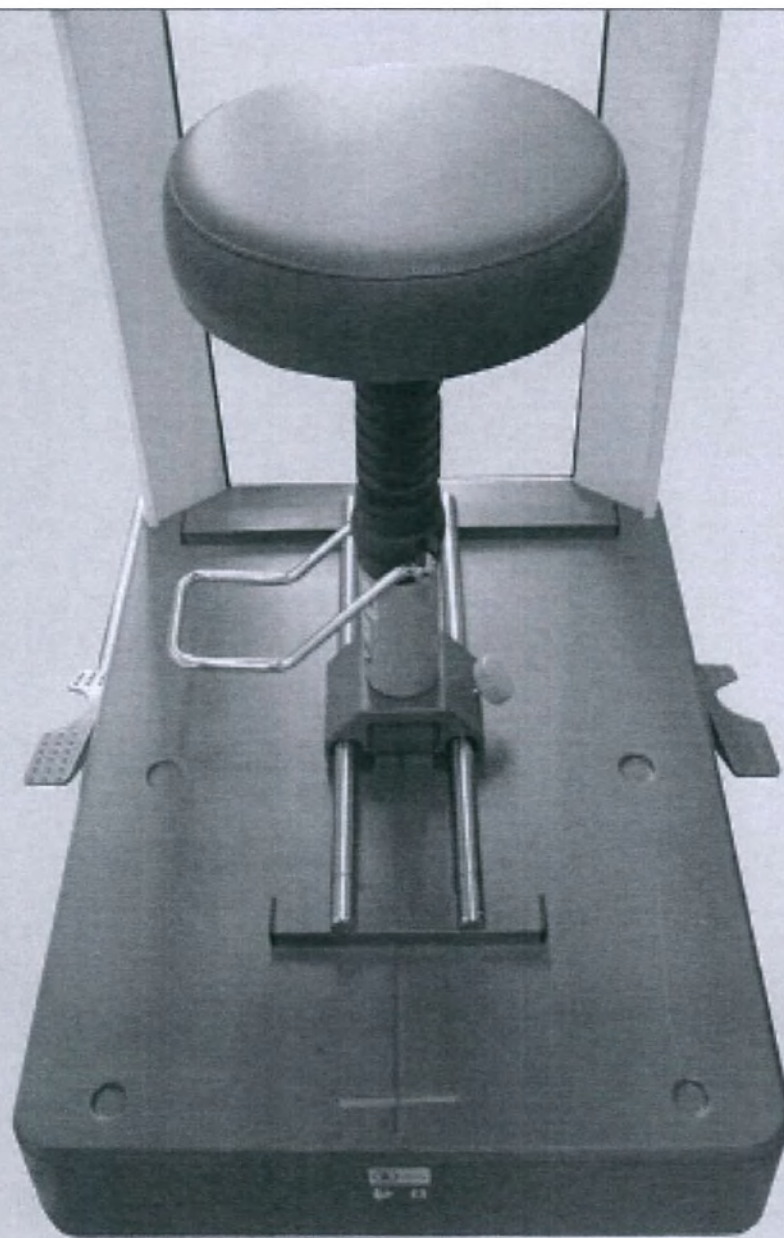

50. Вращающийся стул пациента для универсальной стойки Ortho

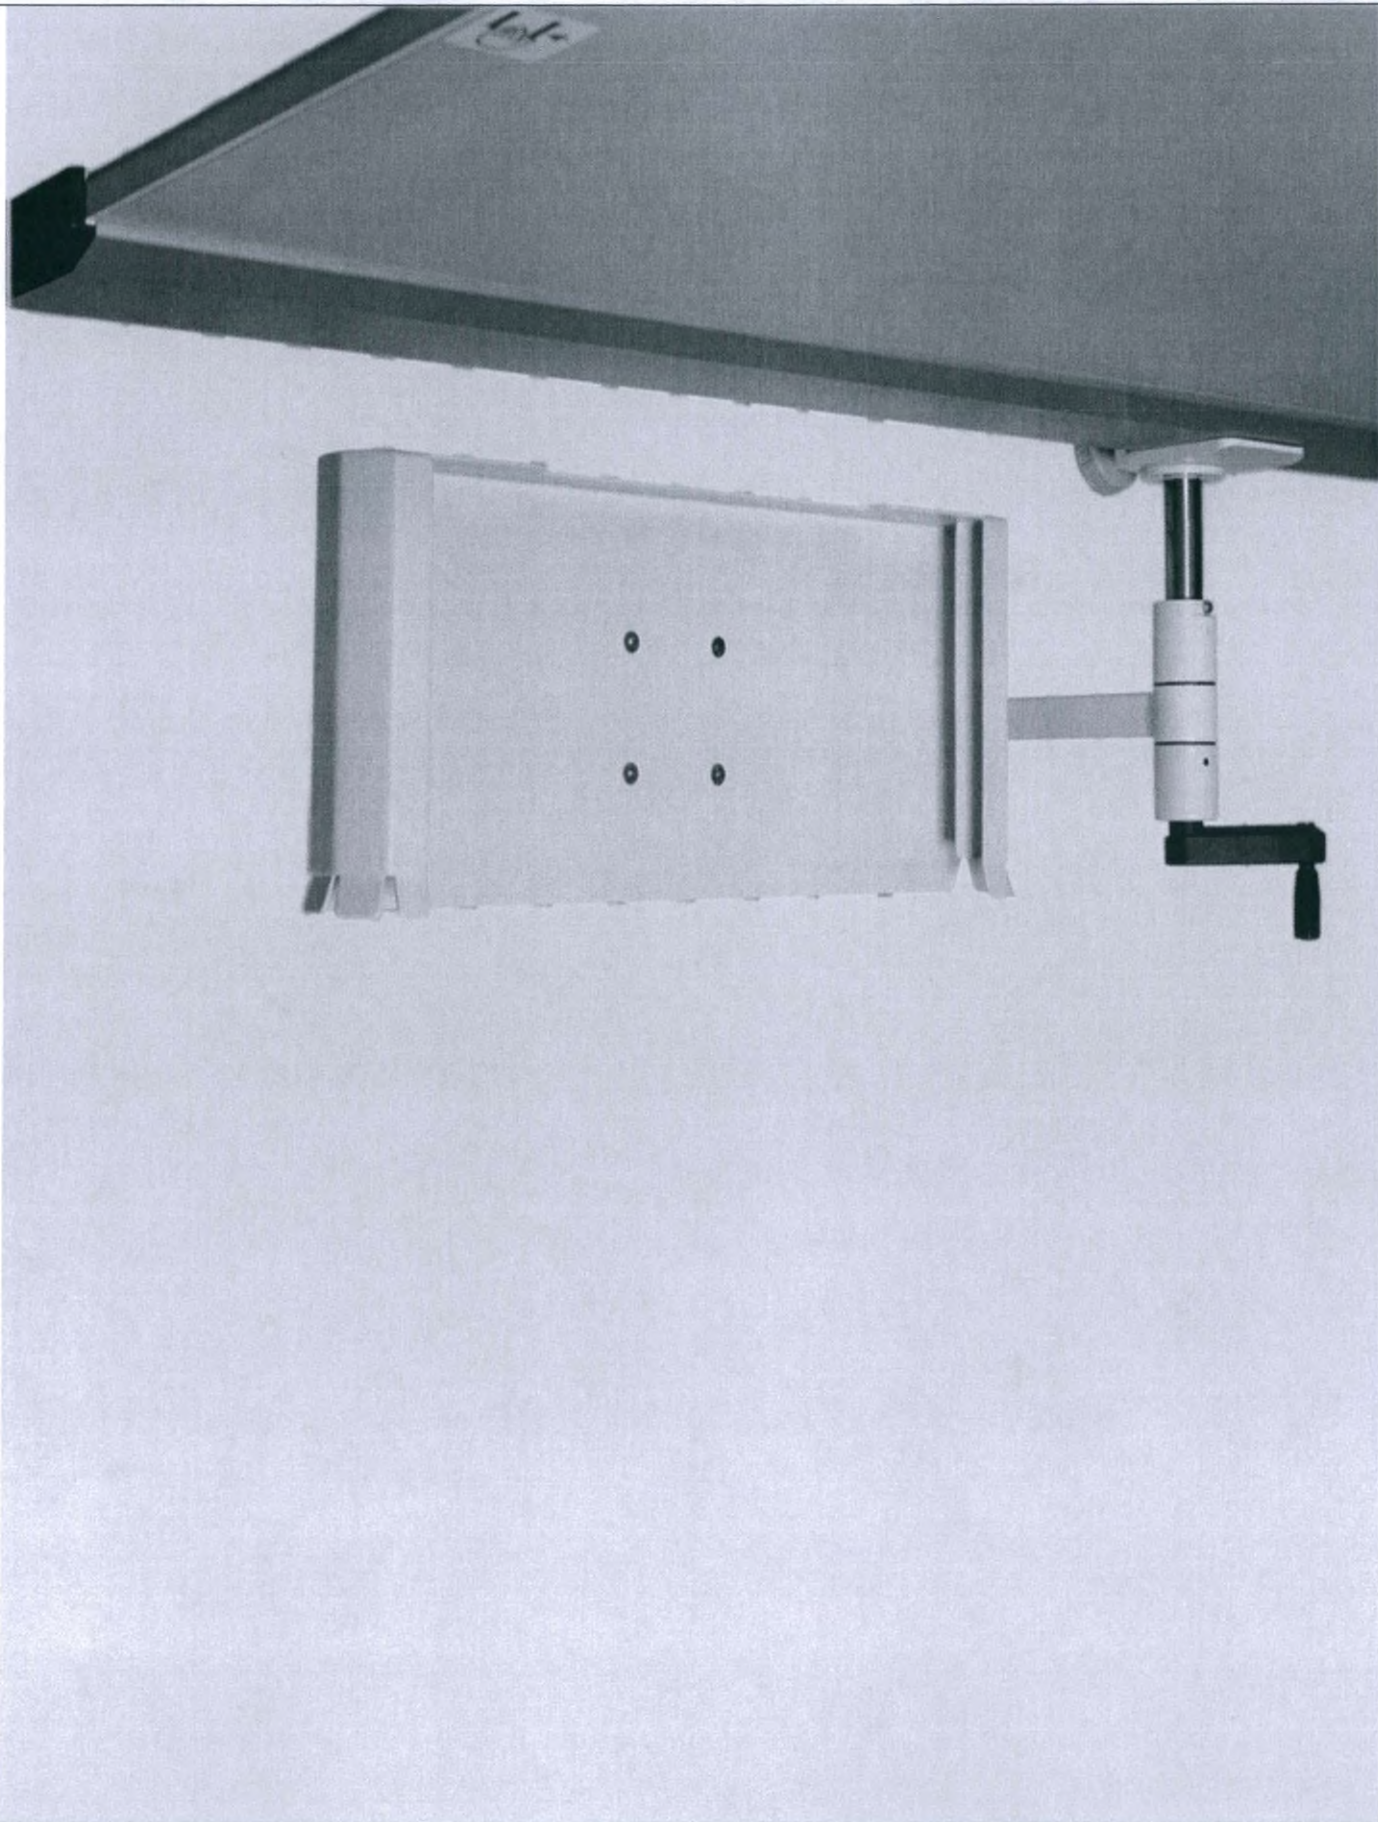


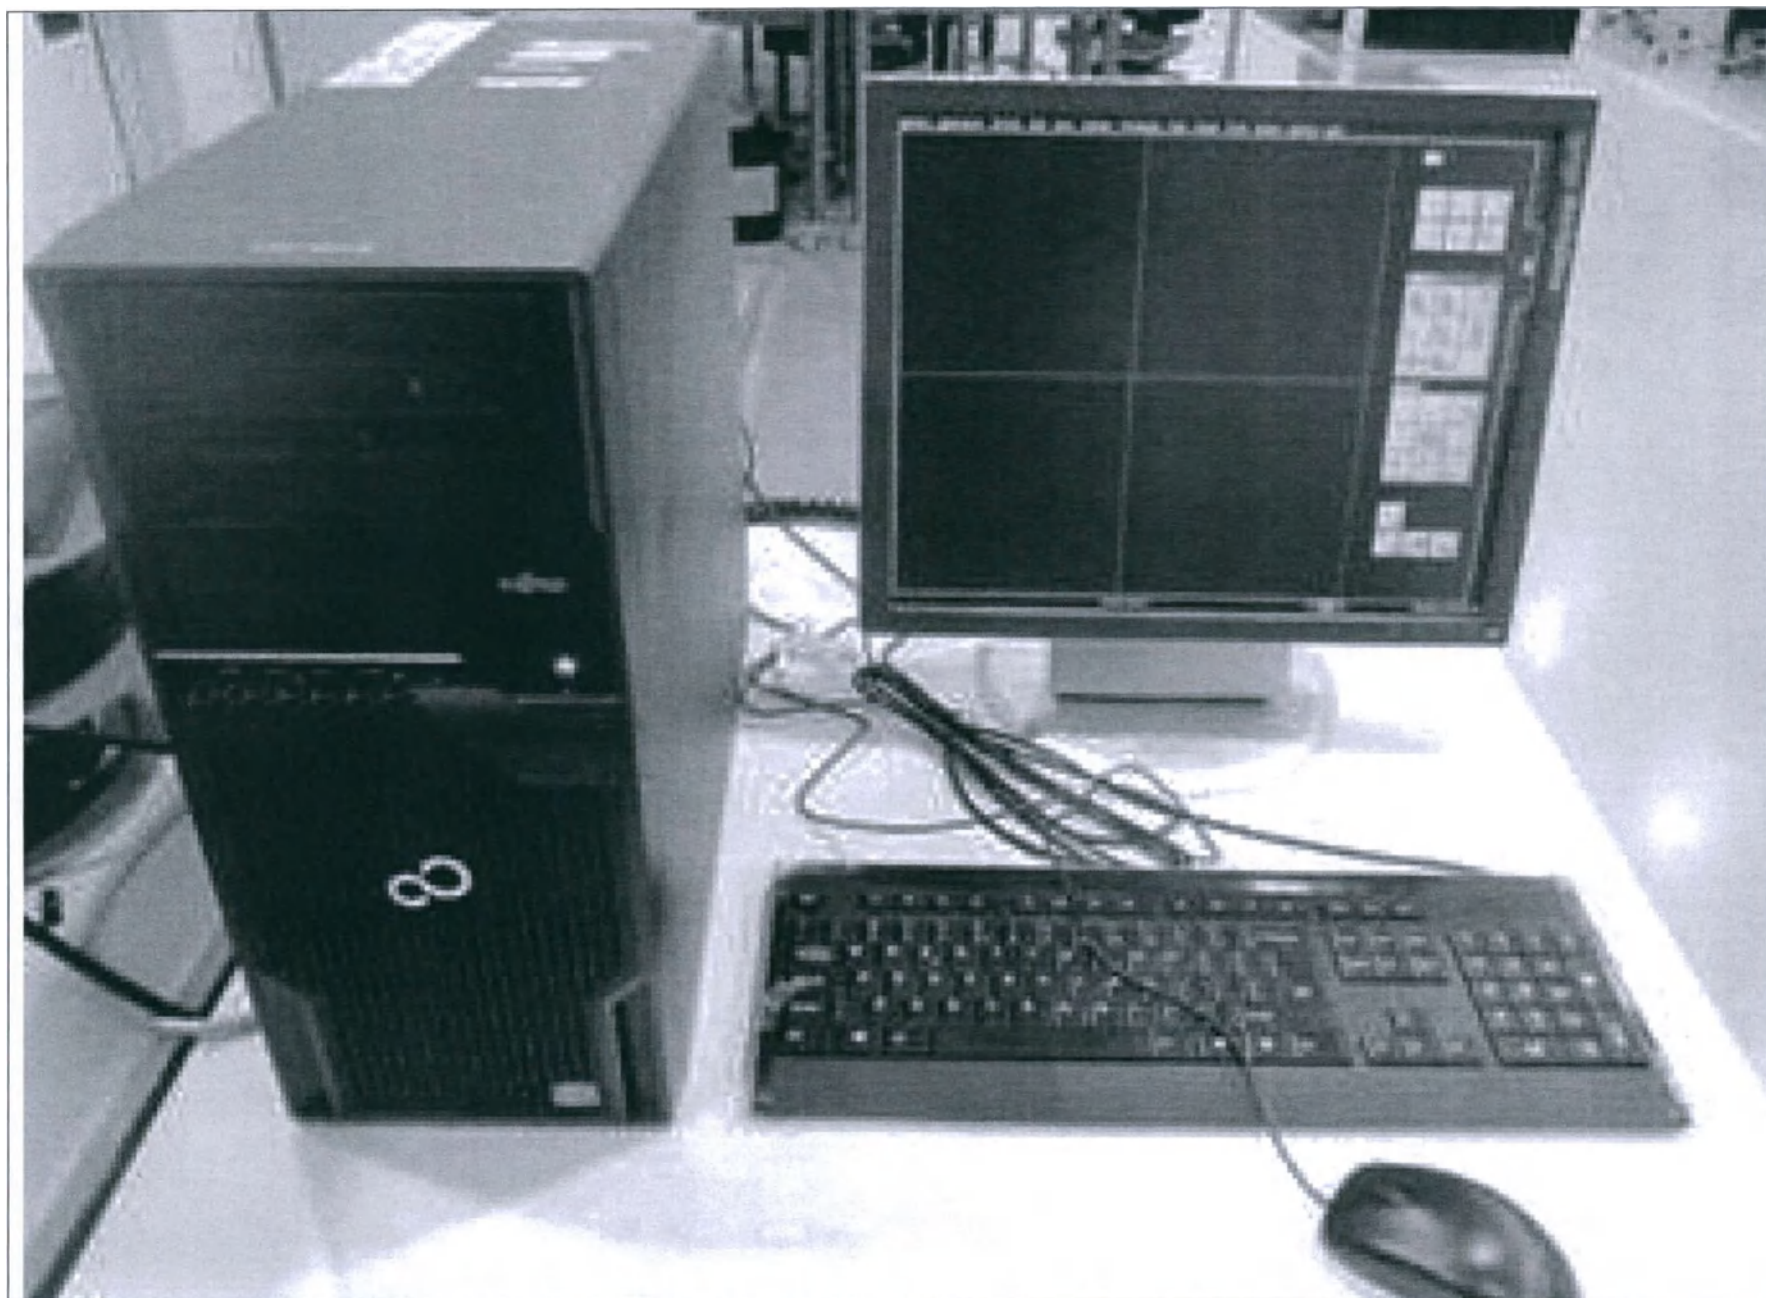


52. Дополнительная консоль управления в составе: - программное обеспечение; - мониторы; - системный блок; - мышь; - клавиатура




53. Дополнительный монитор

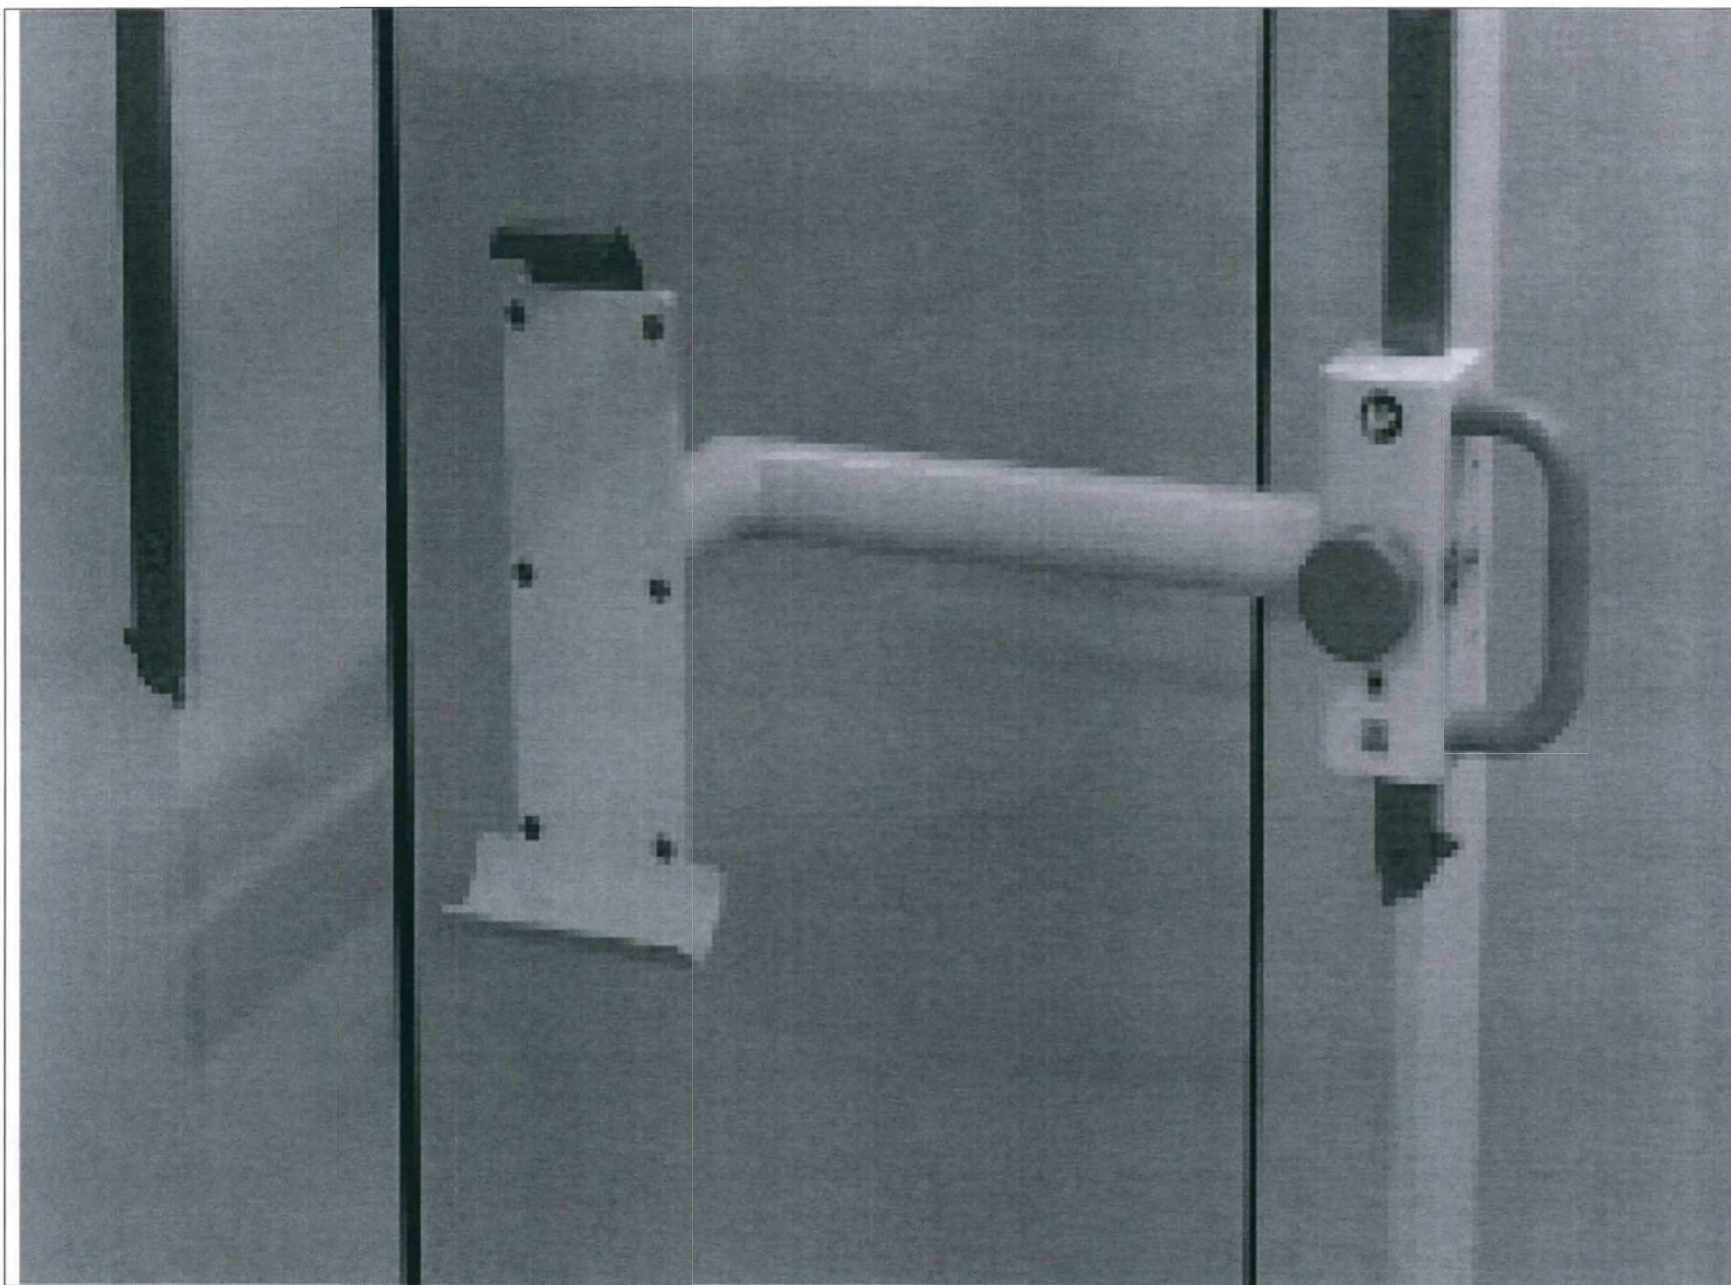


54. Держатель детектора для стойки Ortho

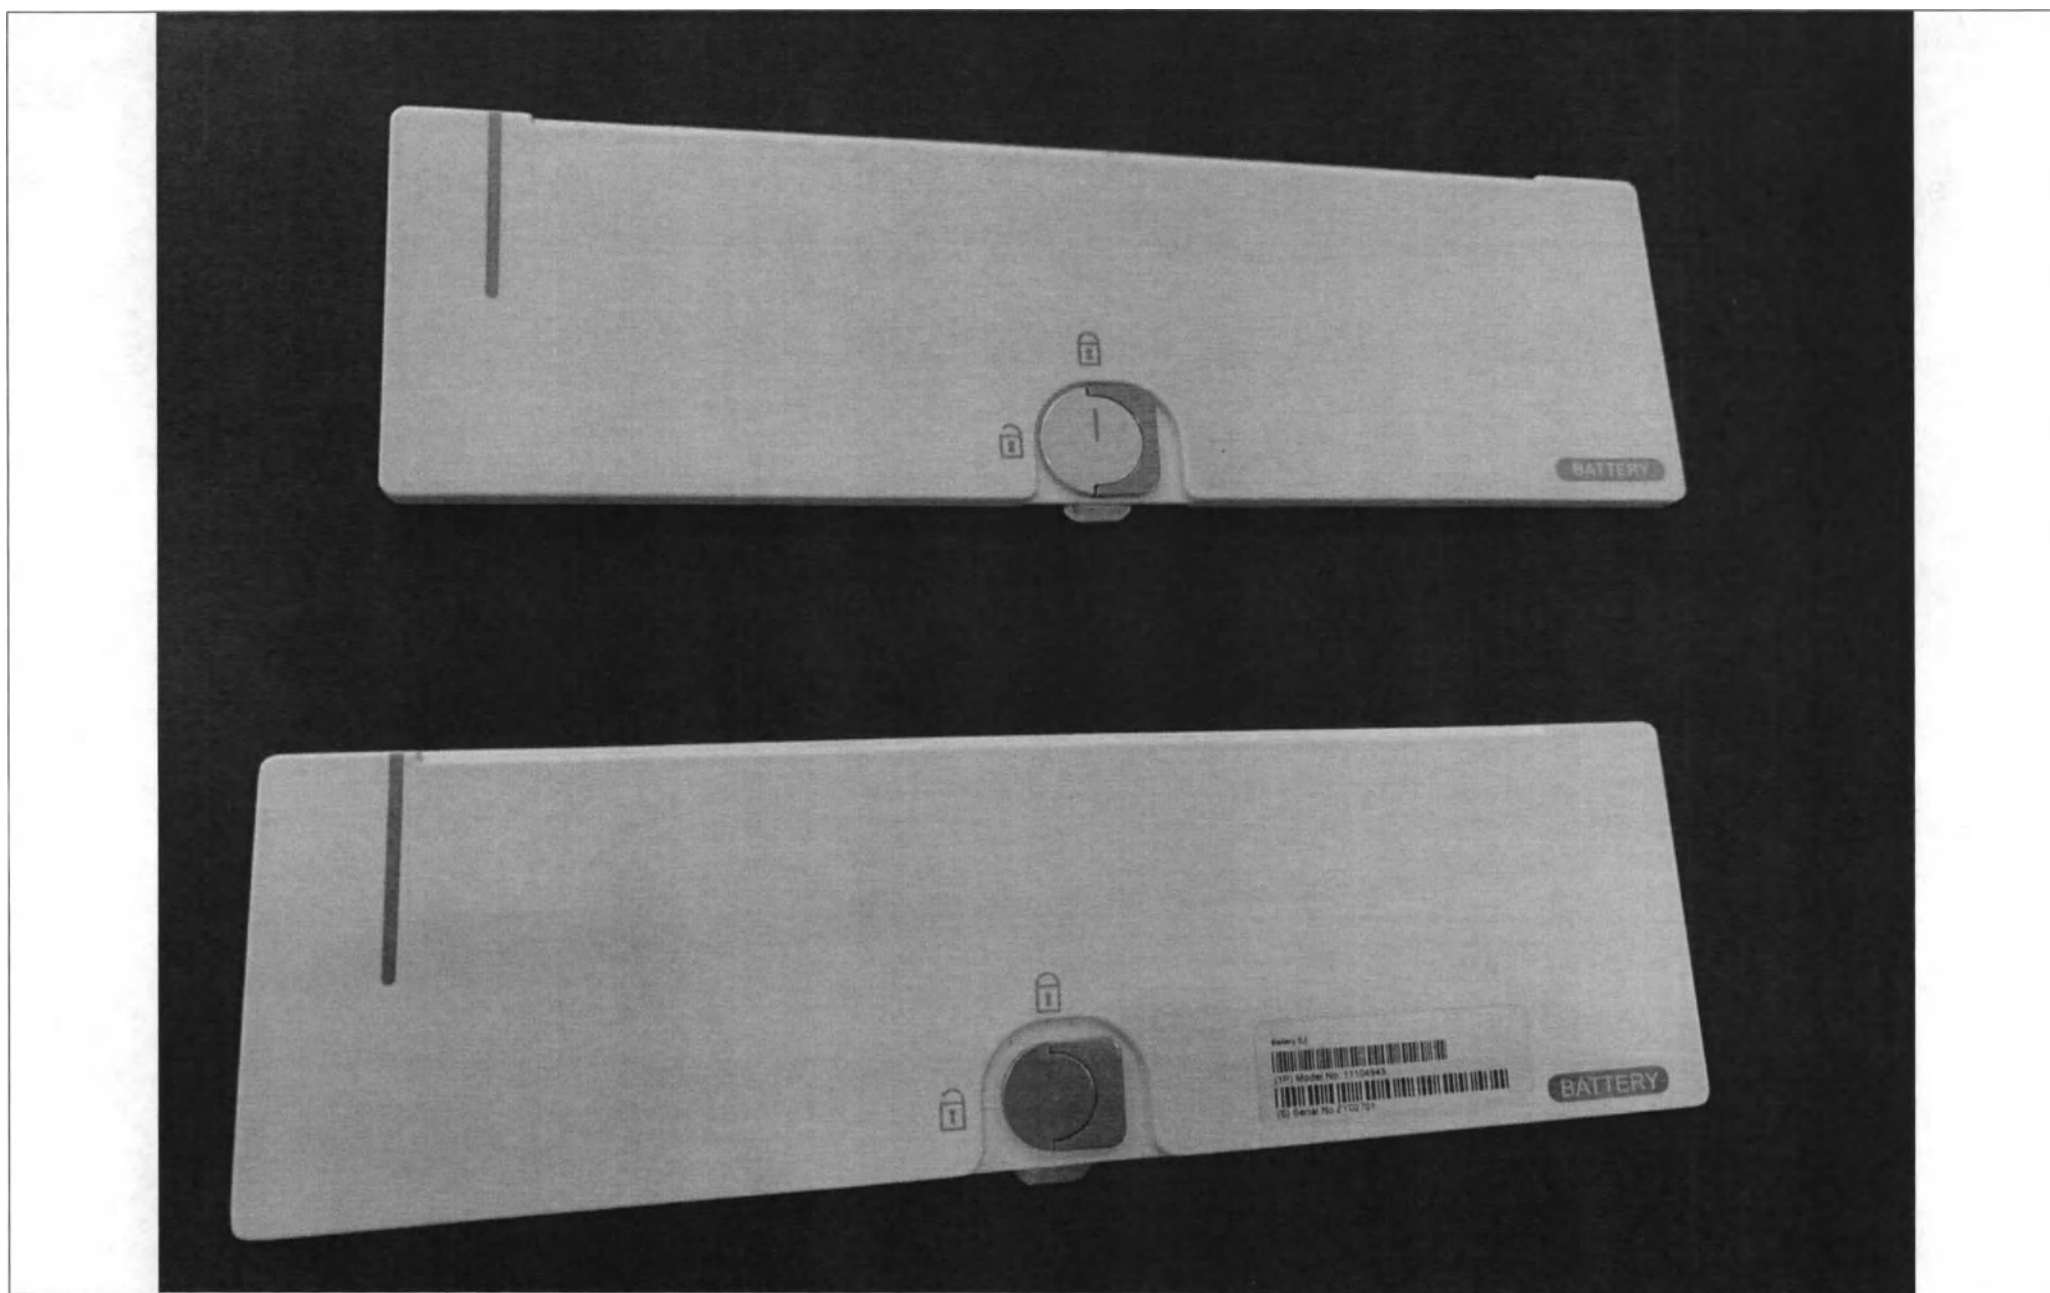


55. Аккумулятор детектора MAX mini и MAX wi-D

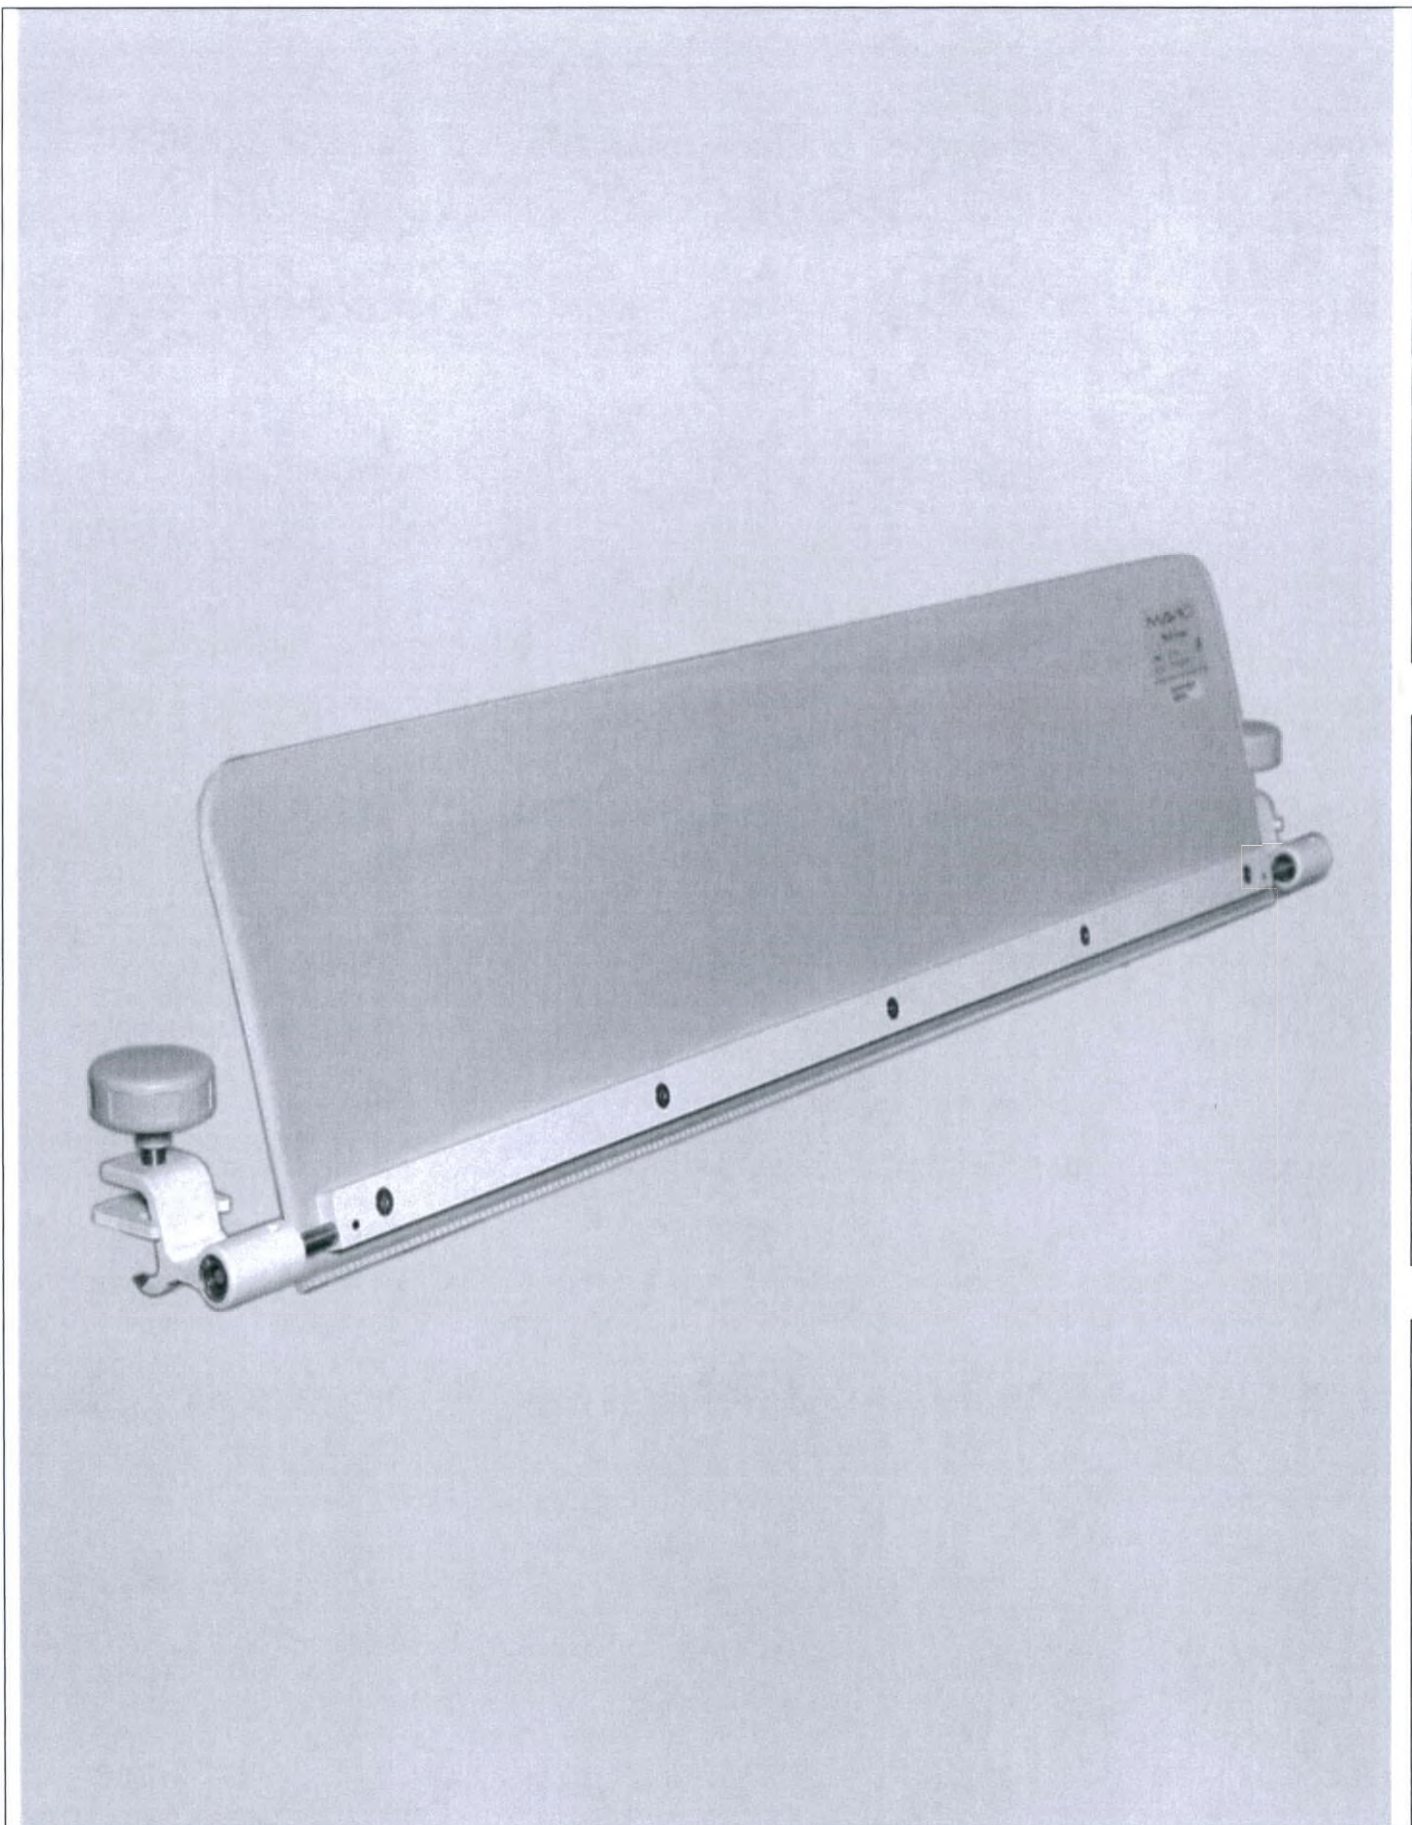


56. Радиационная защита, боковая.

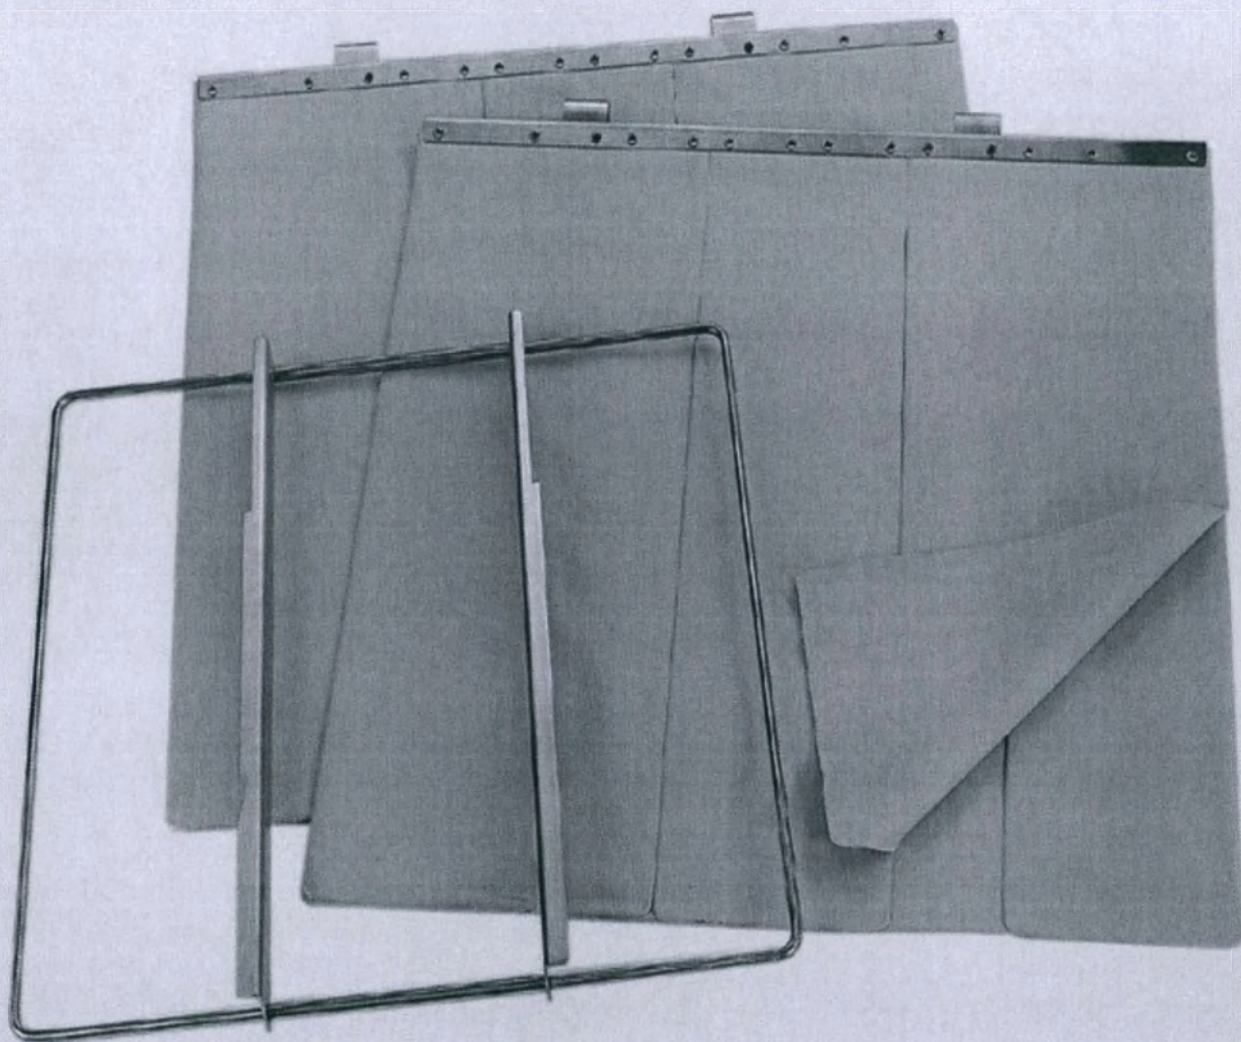

57. Радиационная защита, съёмная

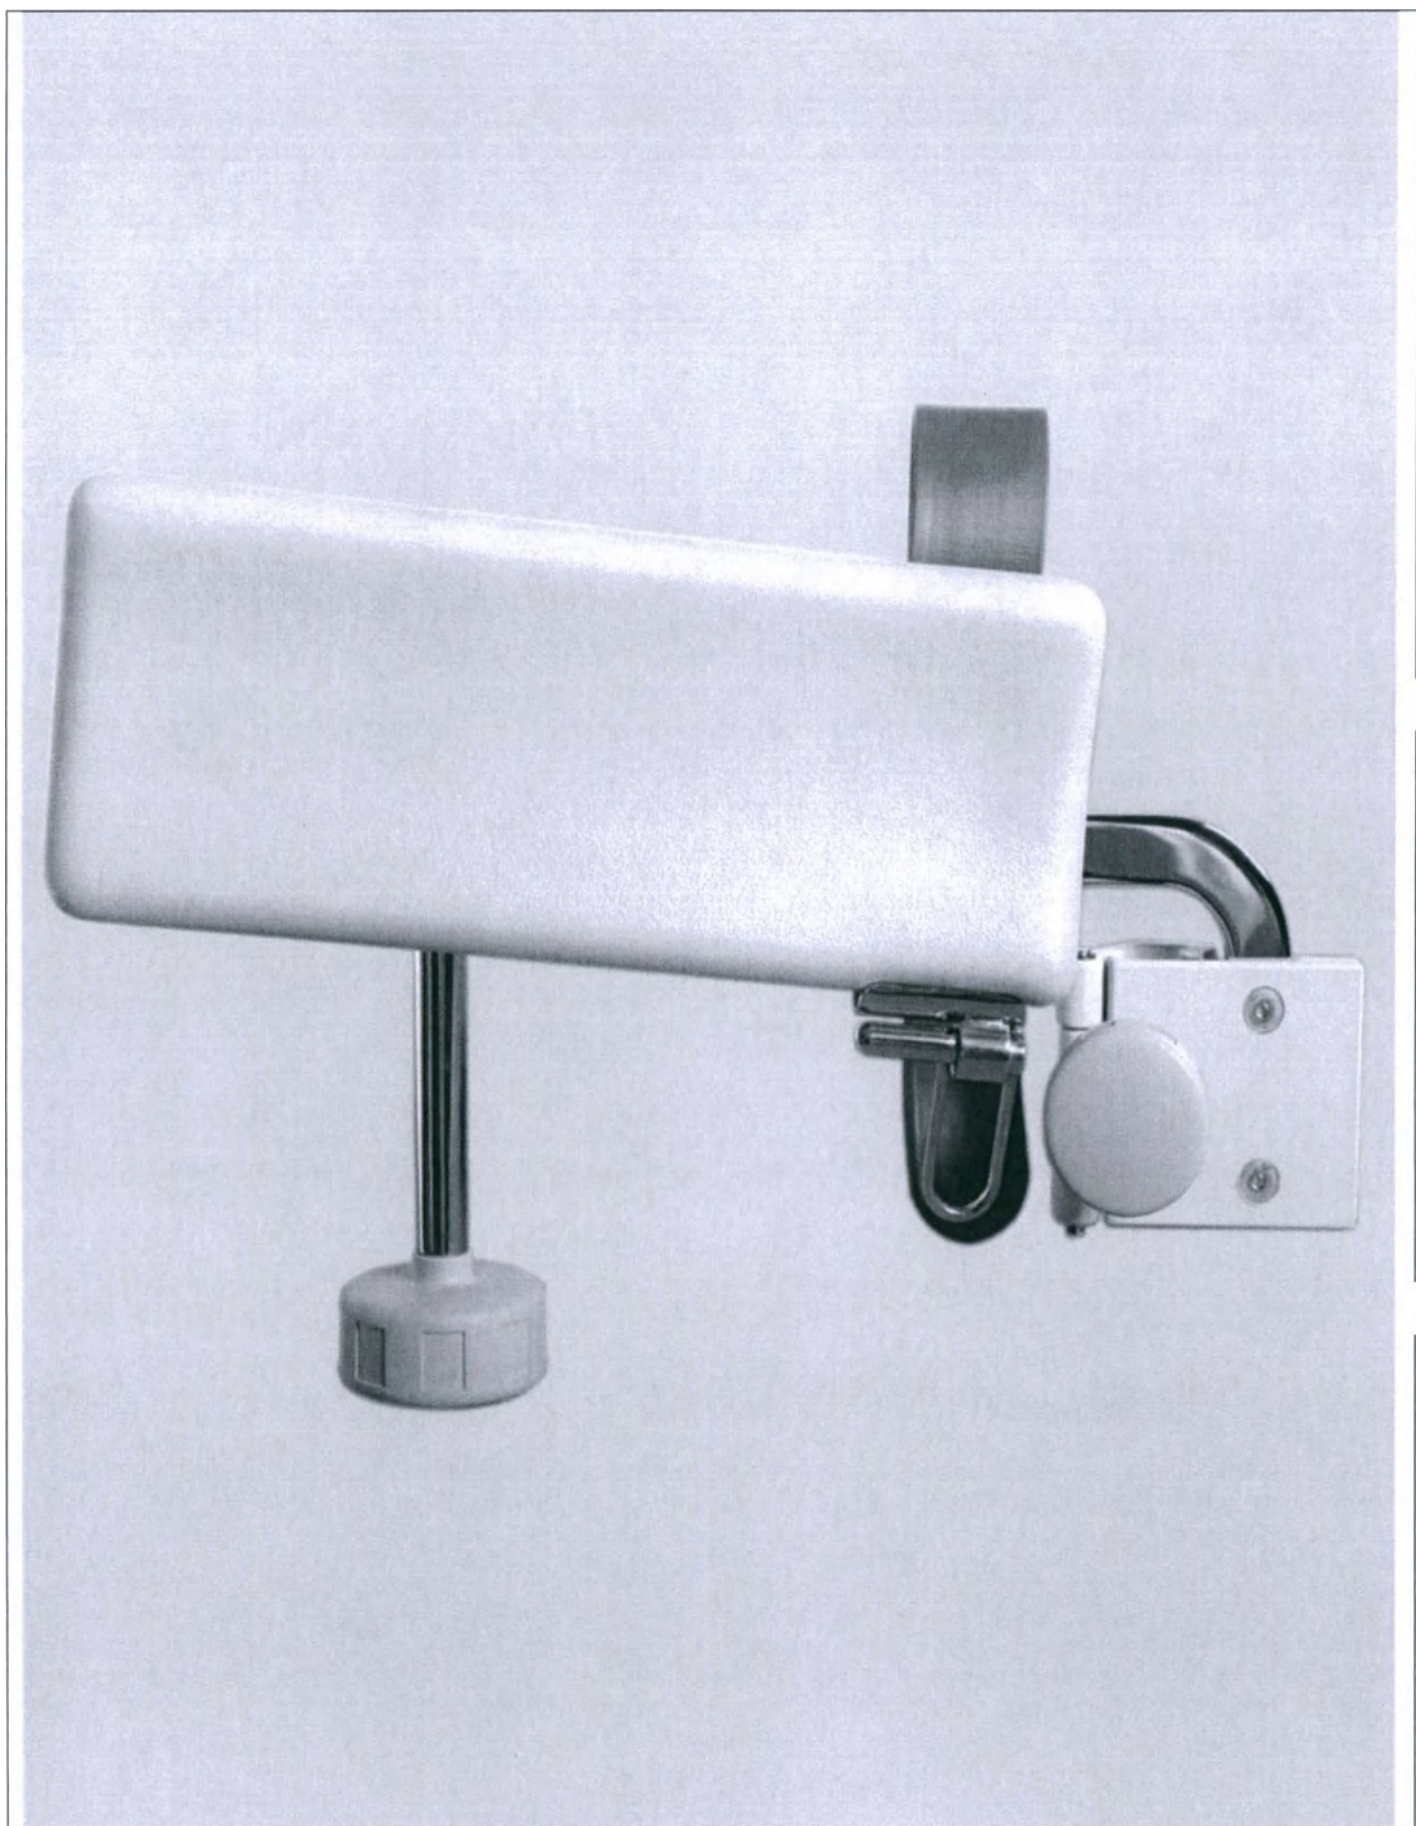


58. Опора для руки.

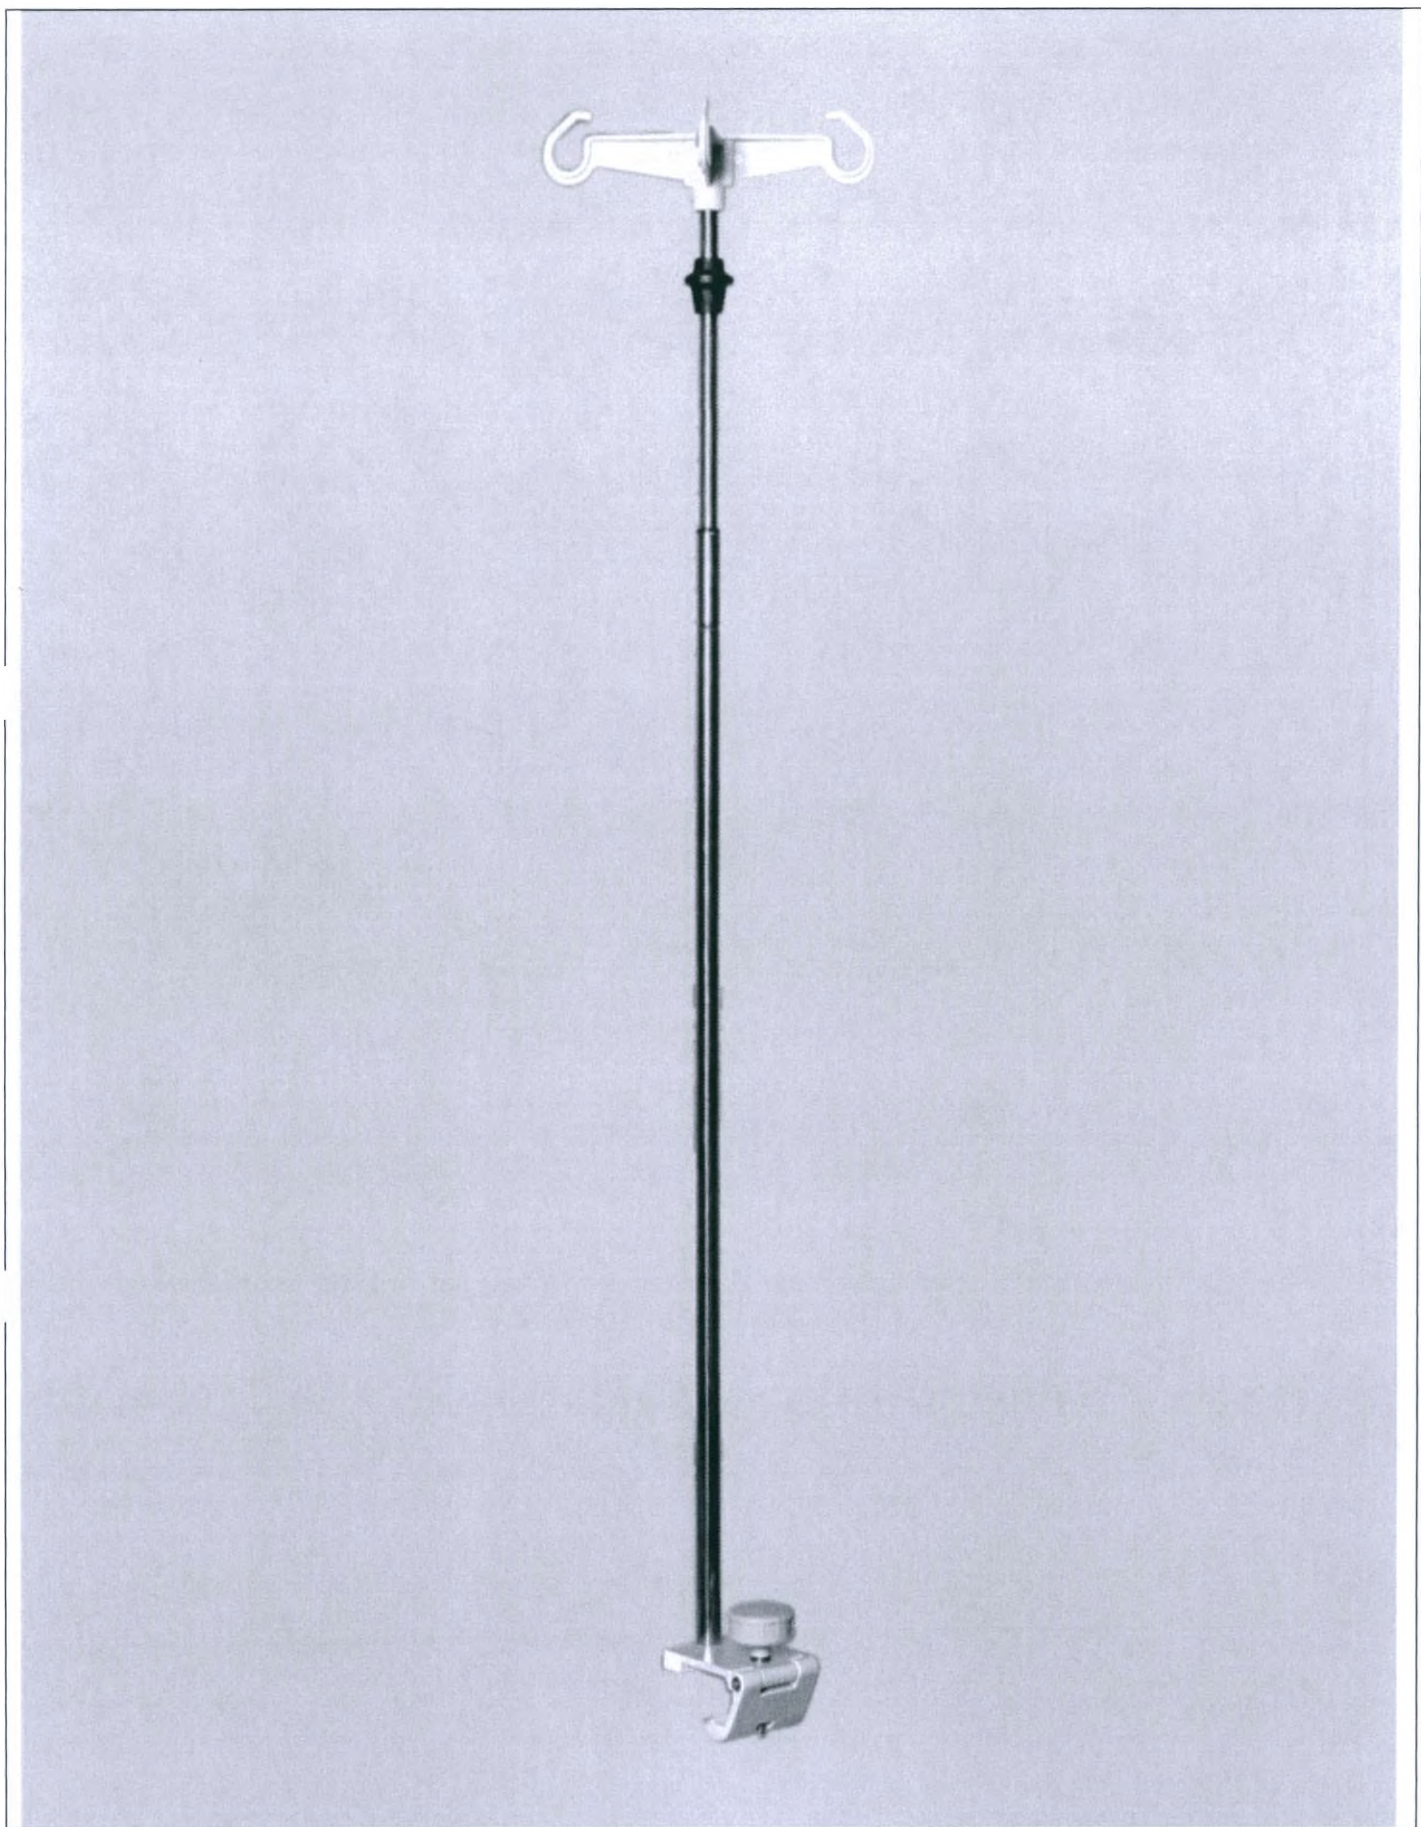


59. Держатель инфузионного сосуда.




60. Рентгенопрозрачный конус

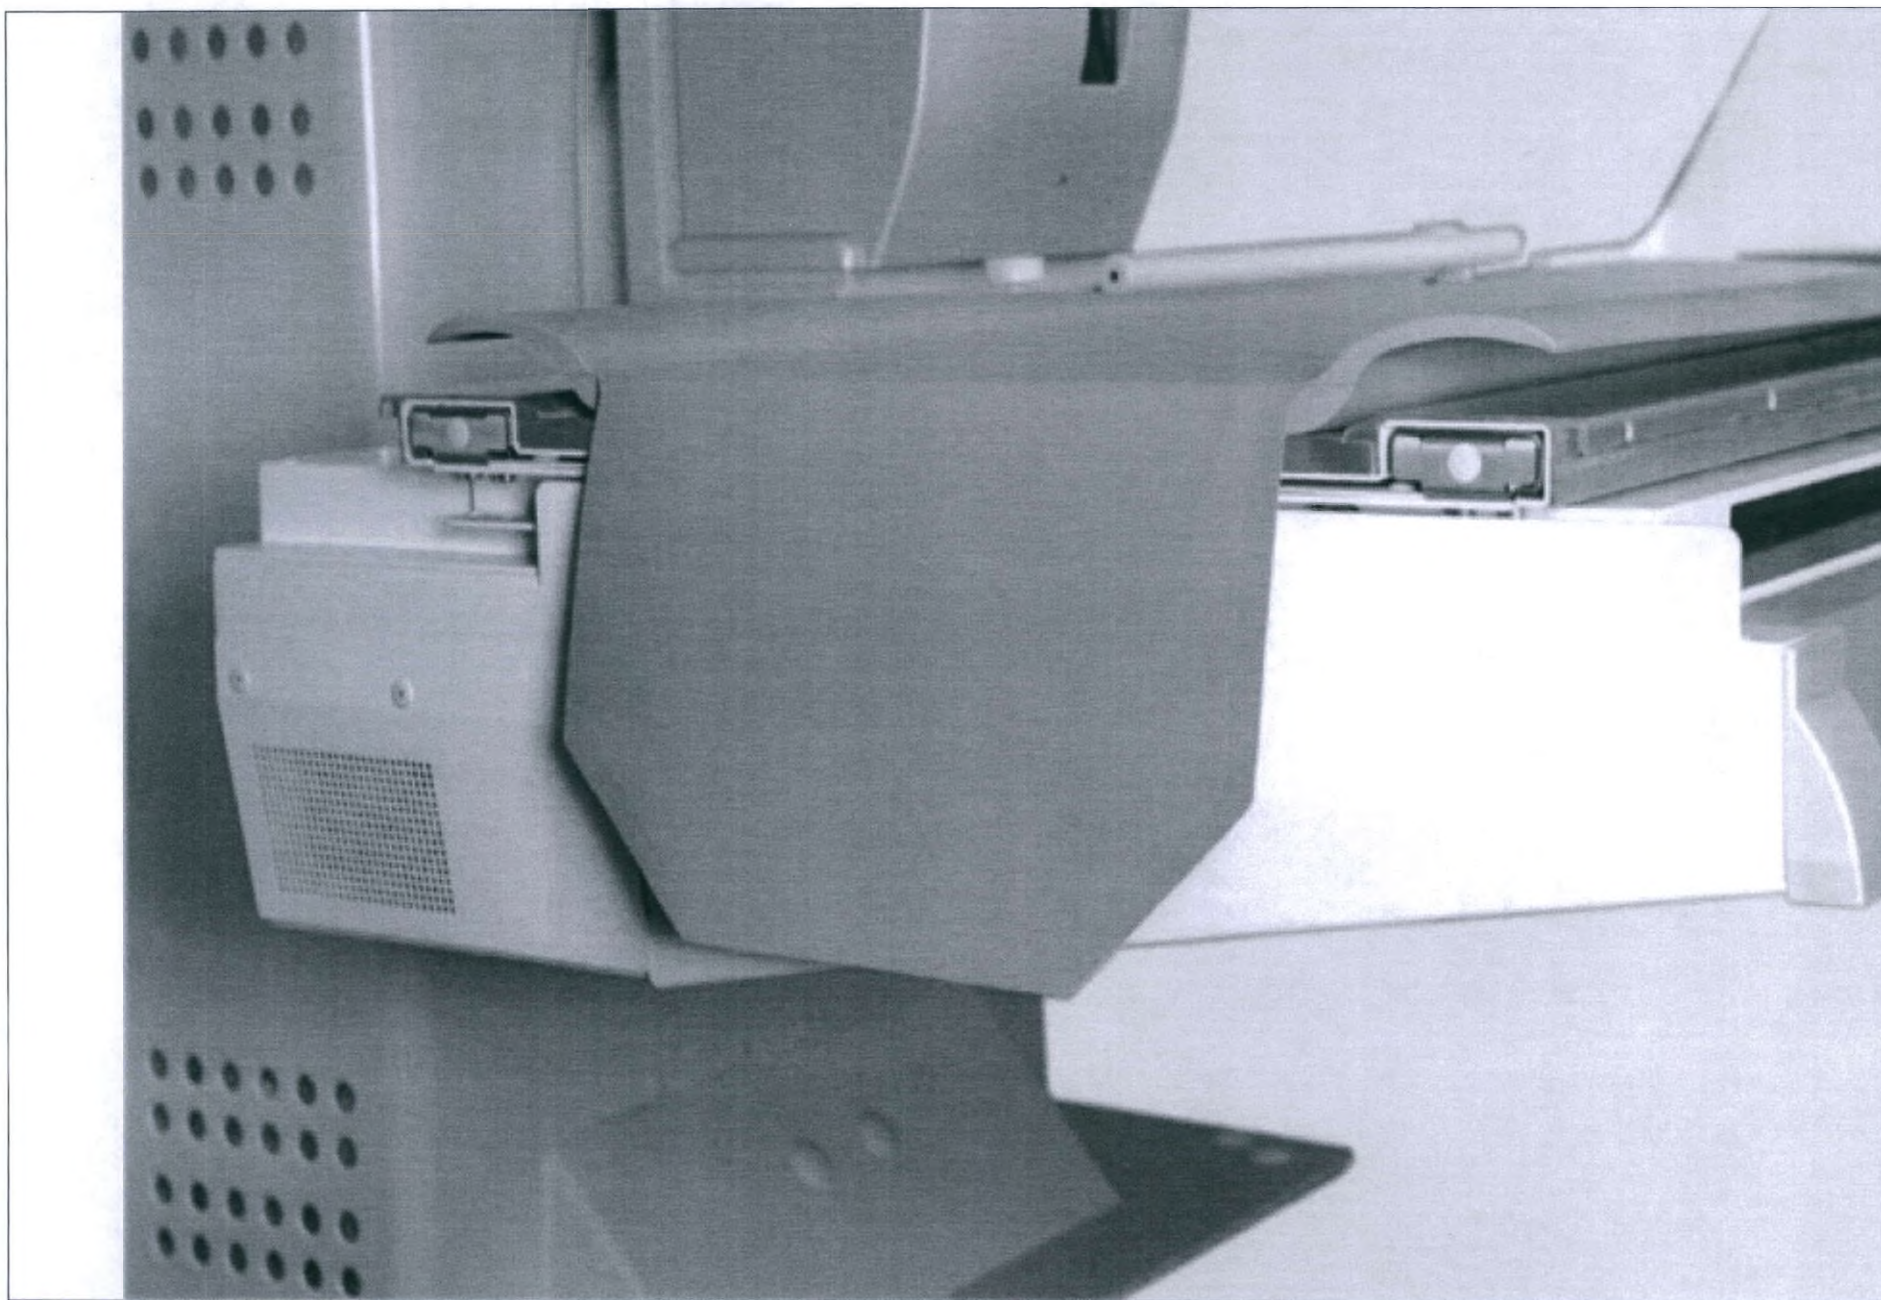


61. Матрац для позиционирования пациента урологический.

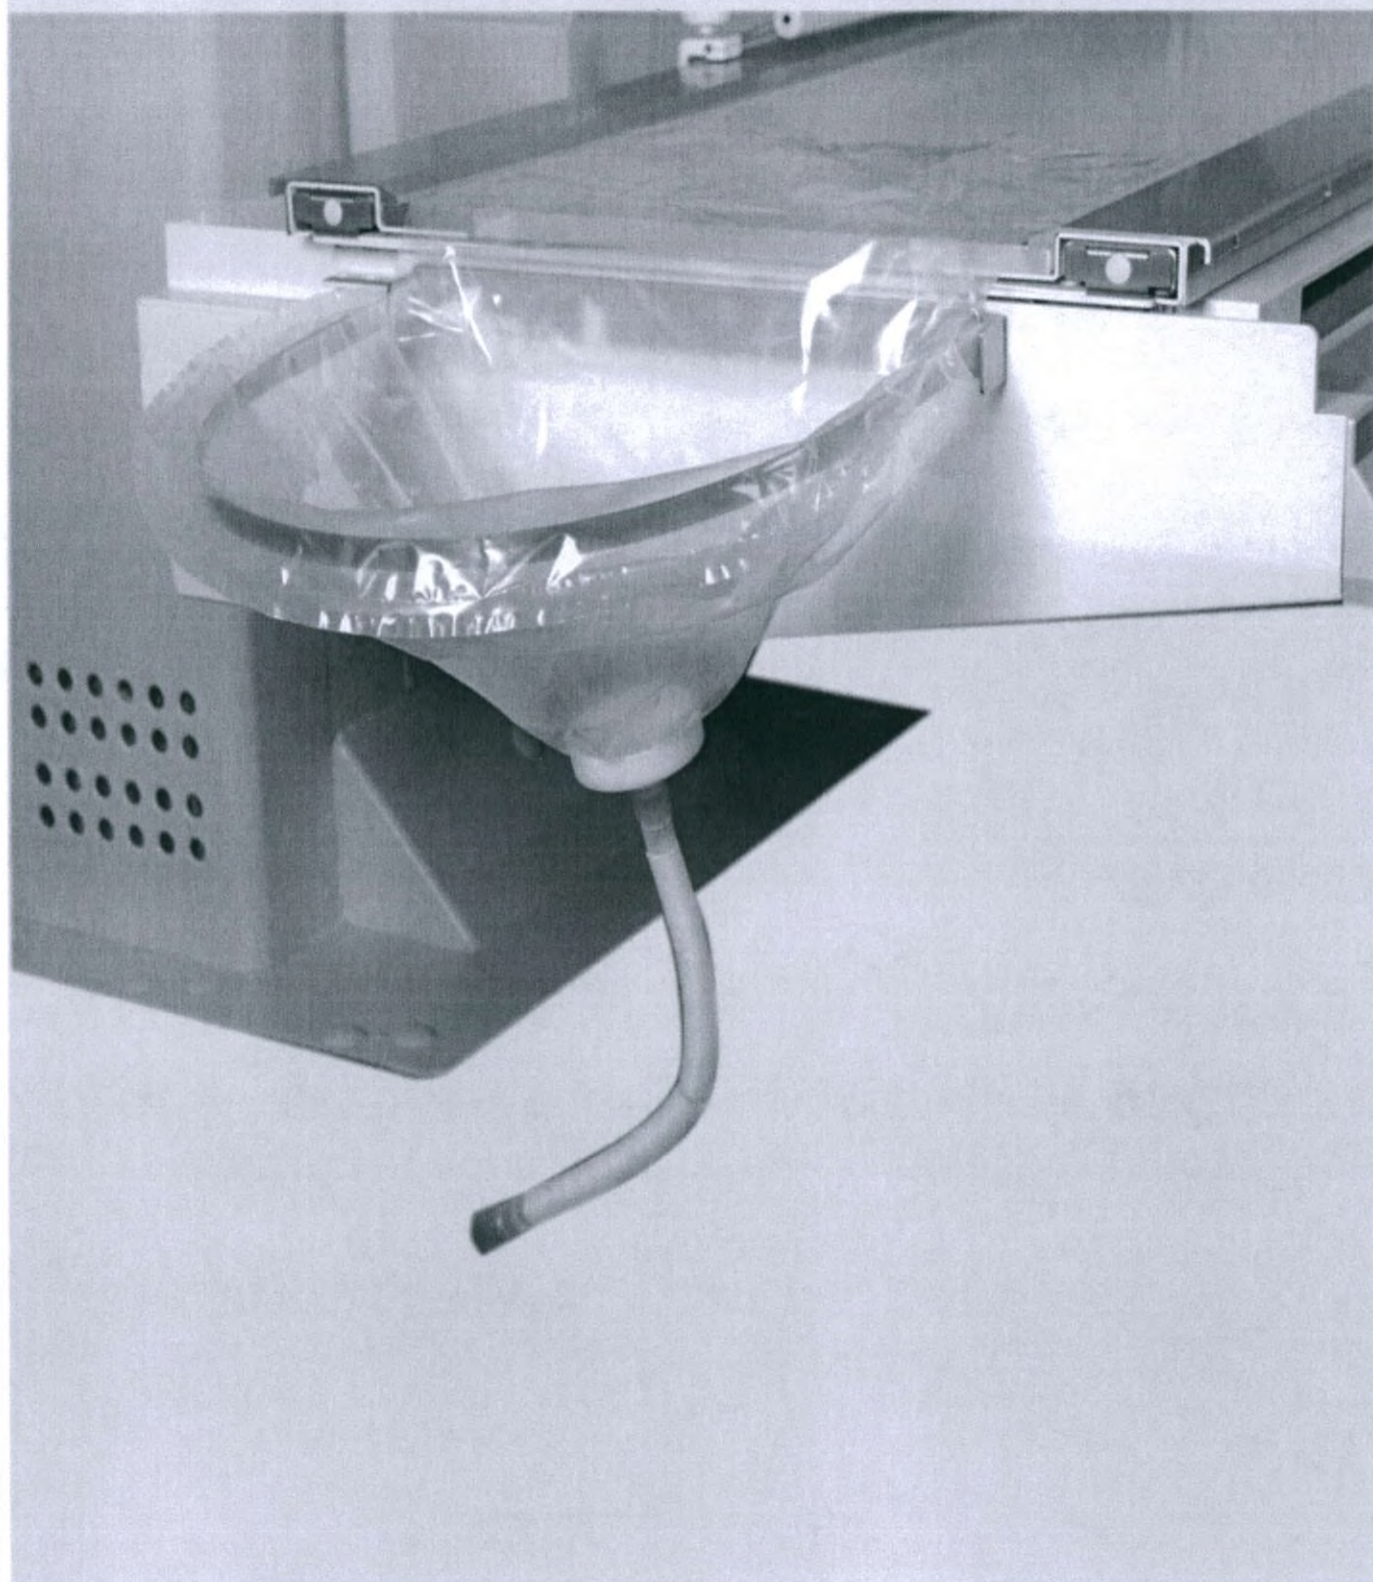


62. Пластиковый дренажный мешок

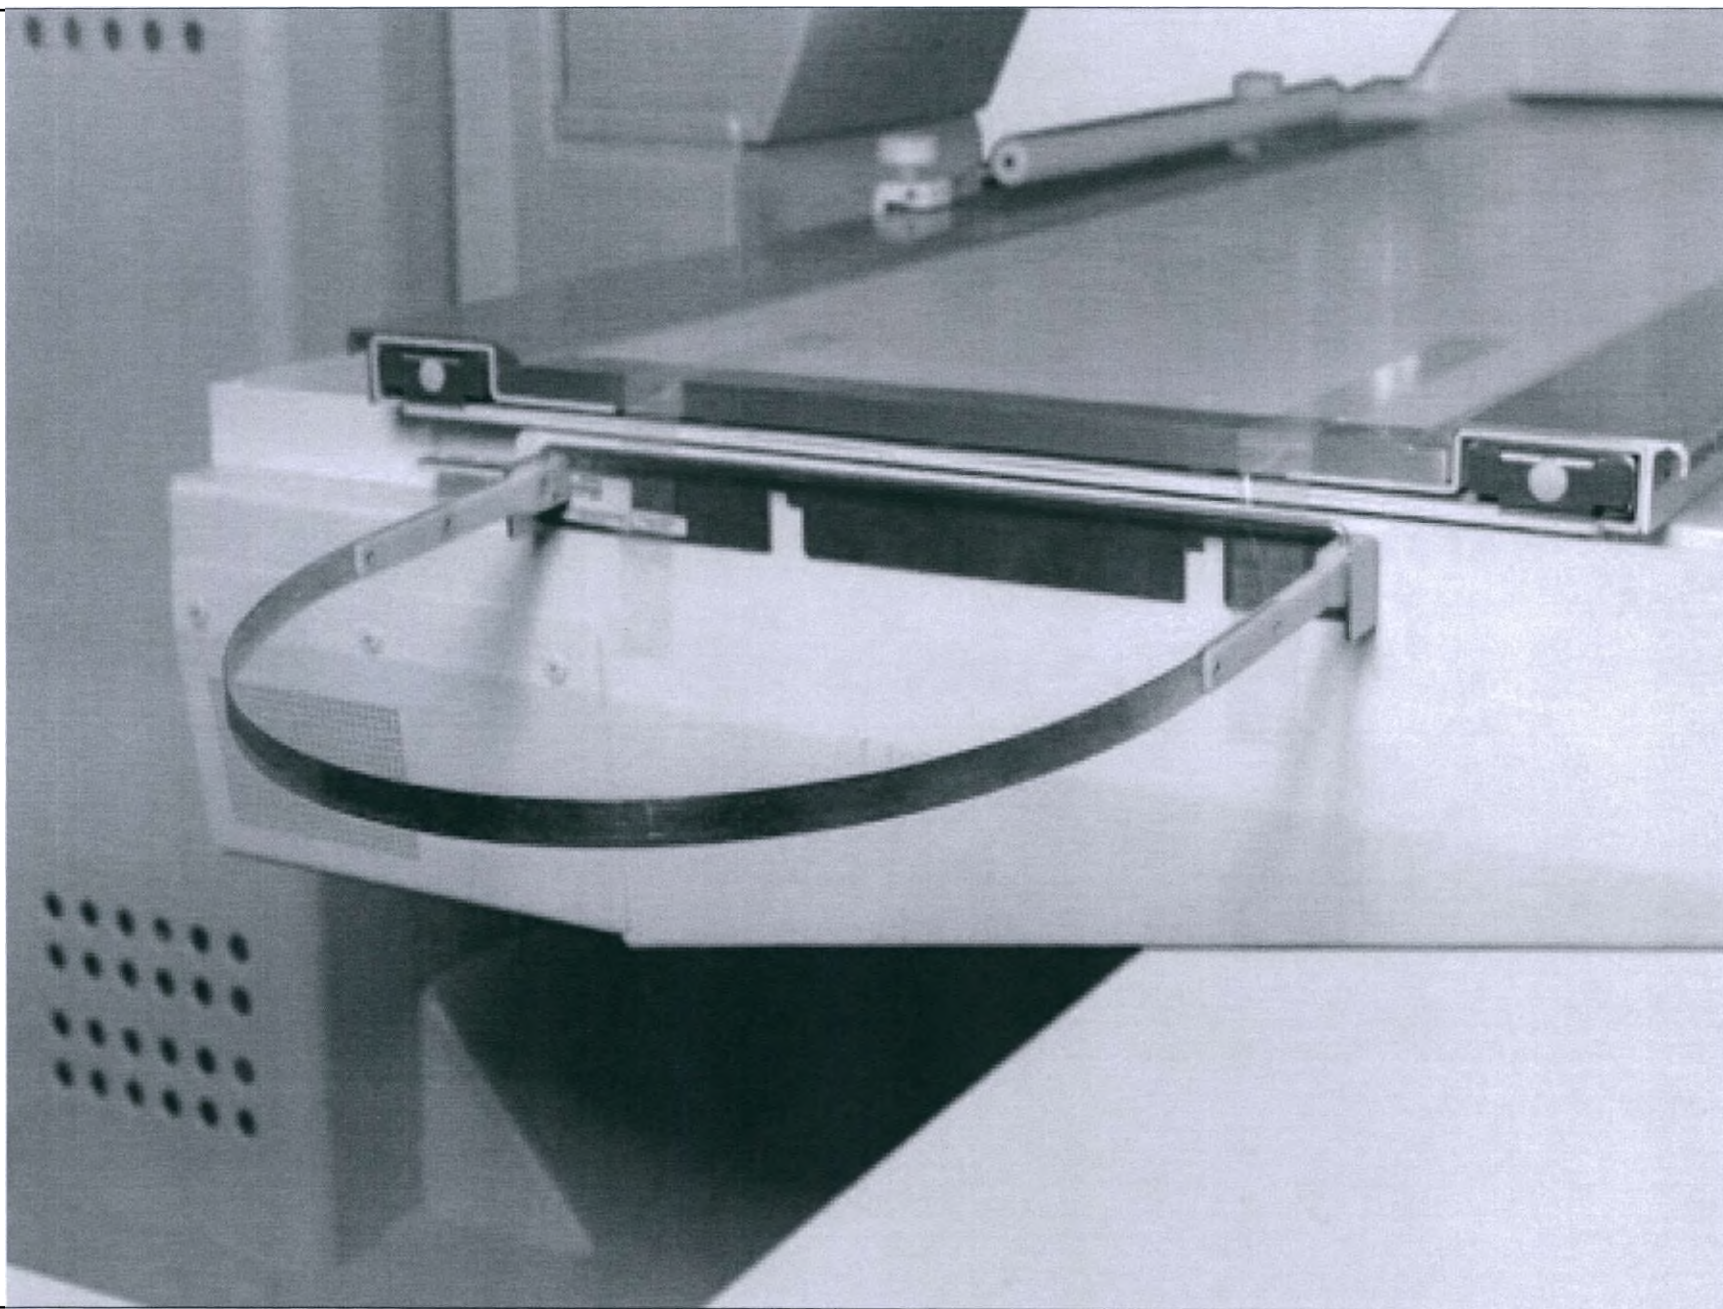


63. Держатель для пластикового дренажного мешка

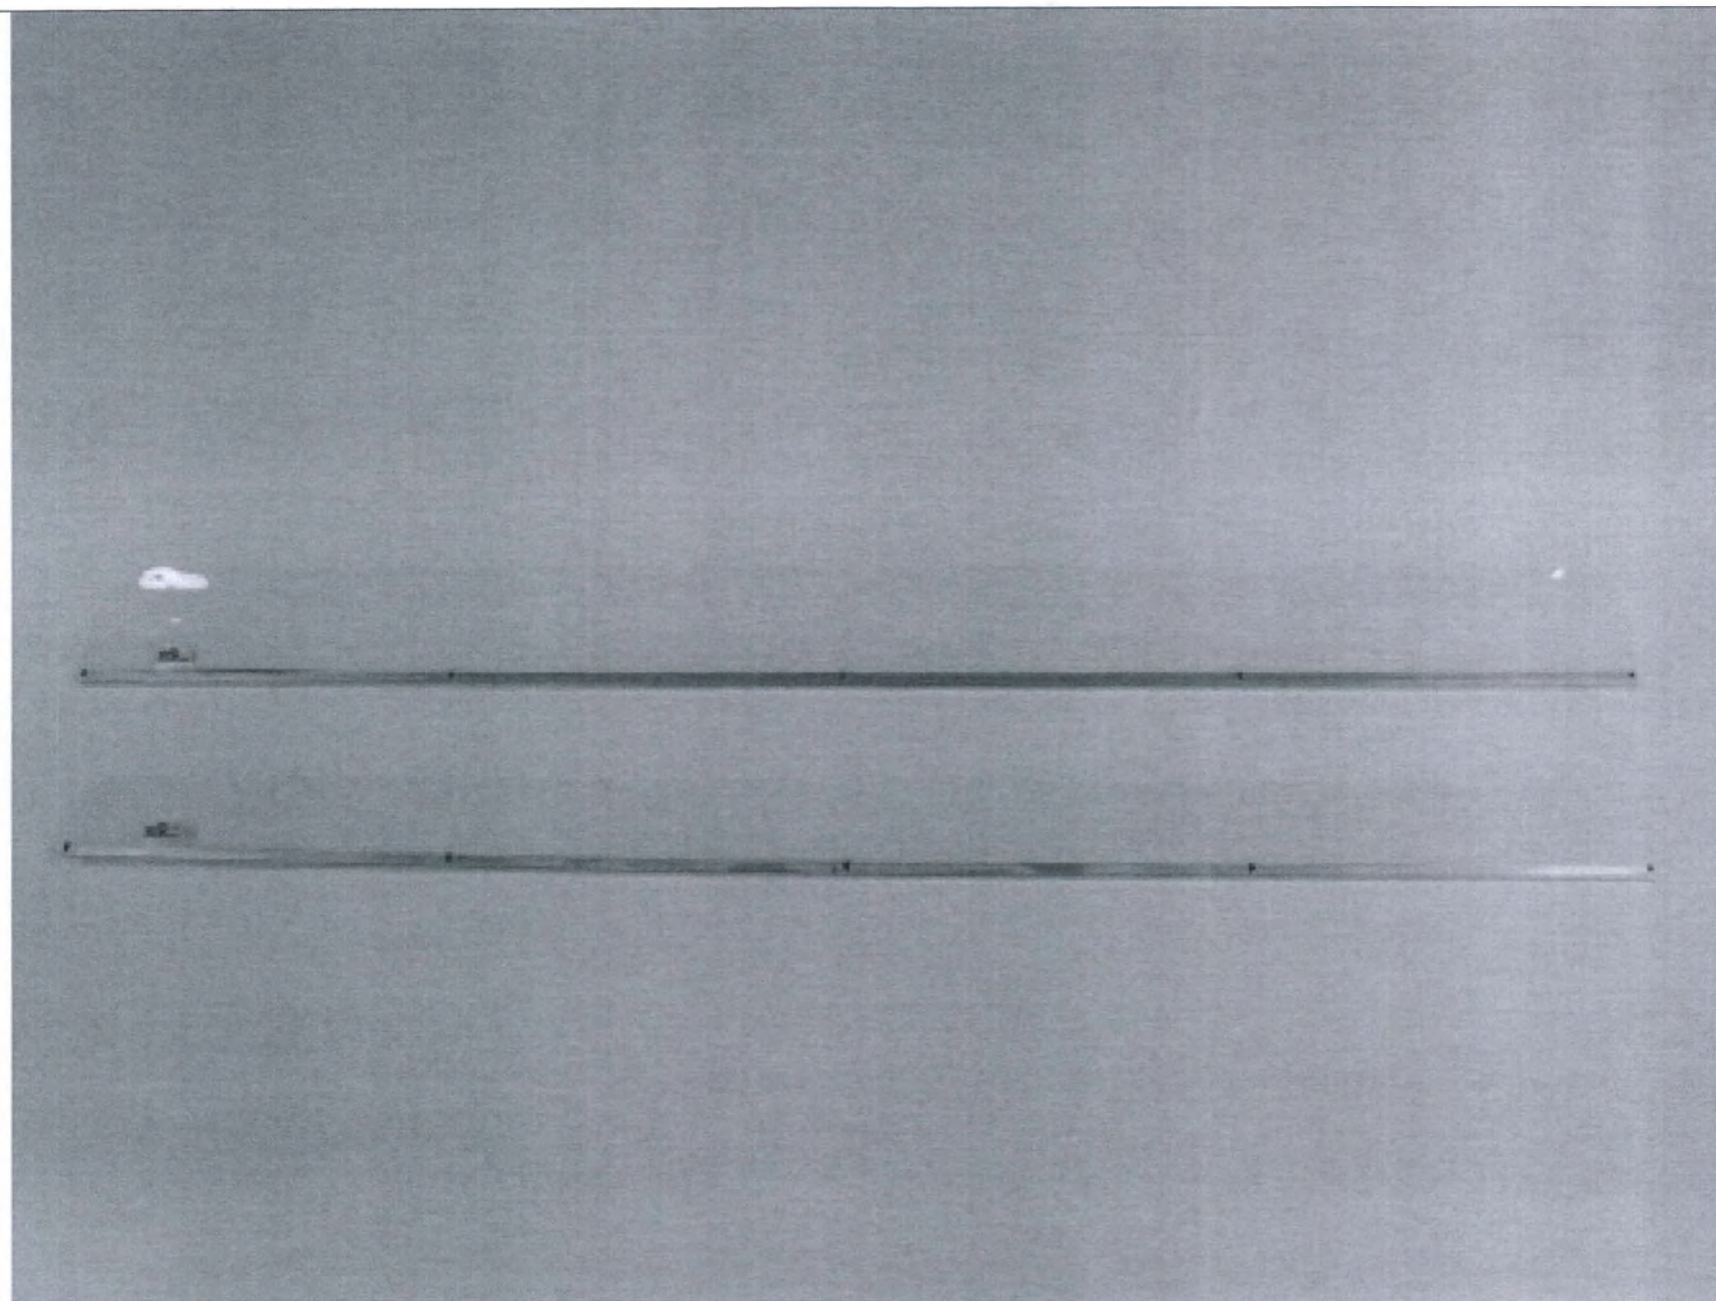


64. Устройство для защиты от излучения, продольное

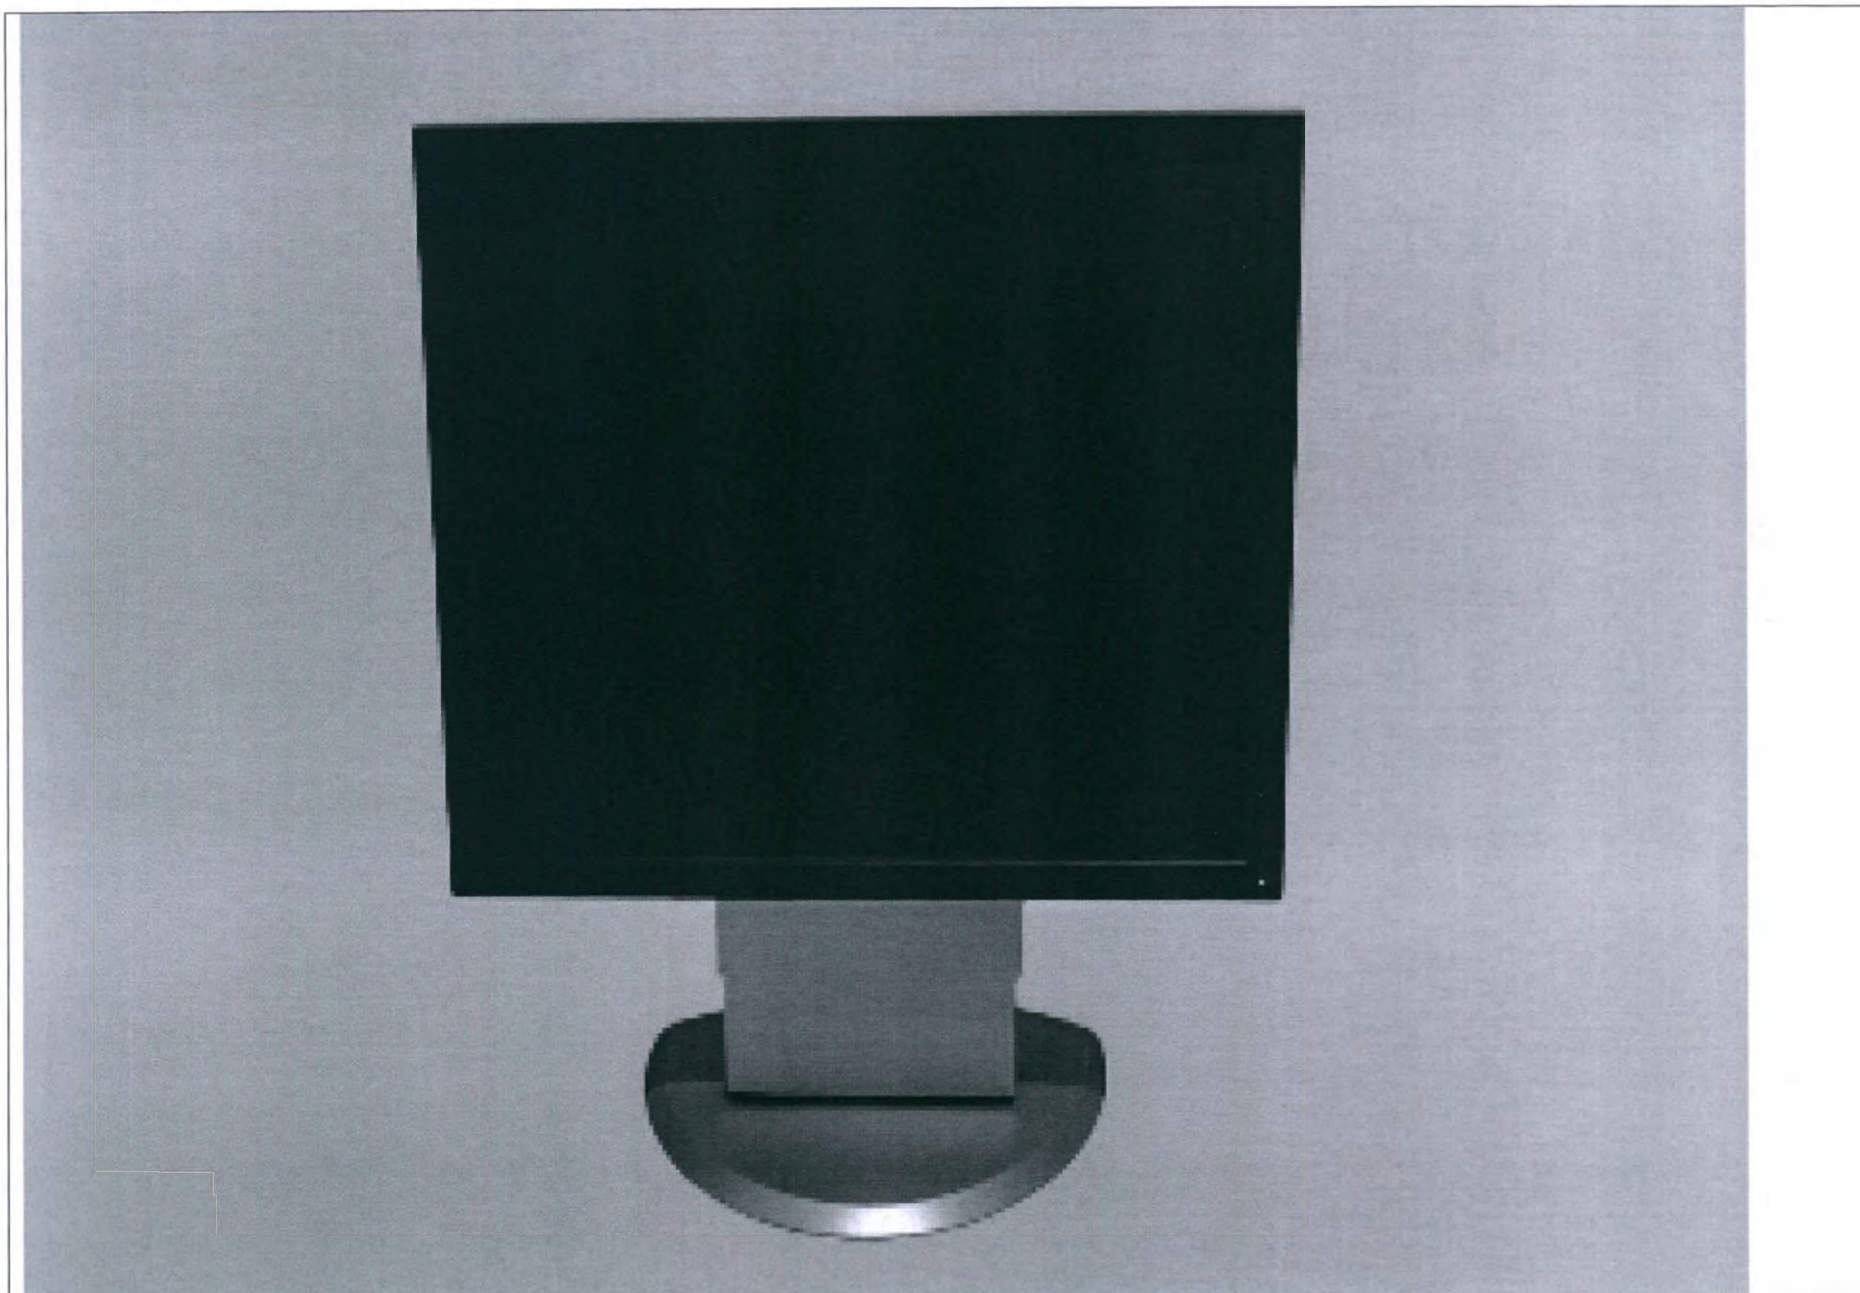


66. Лицензионный ключ для вывода изображения на второй монитор.

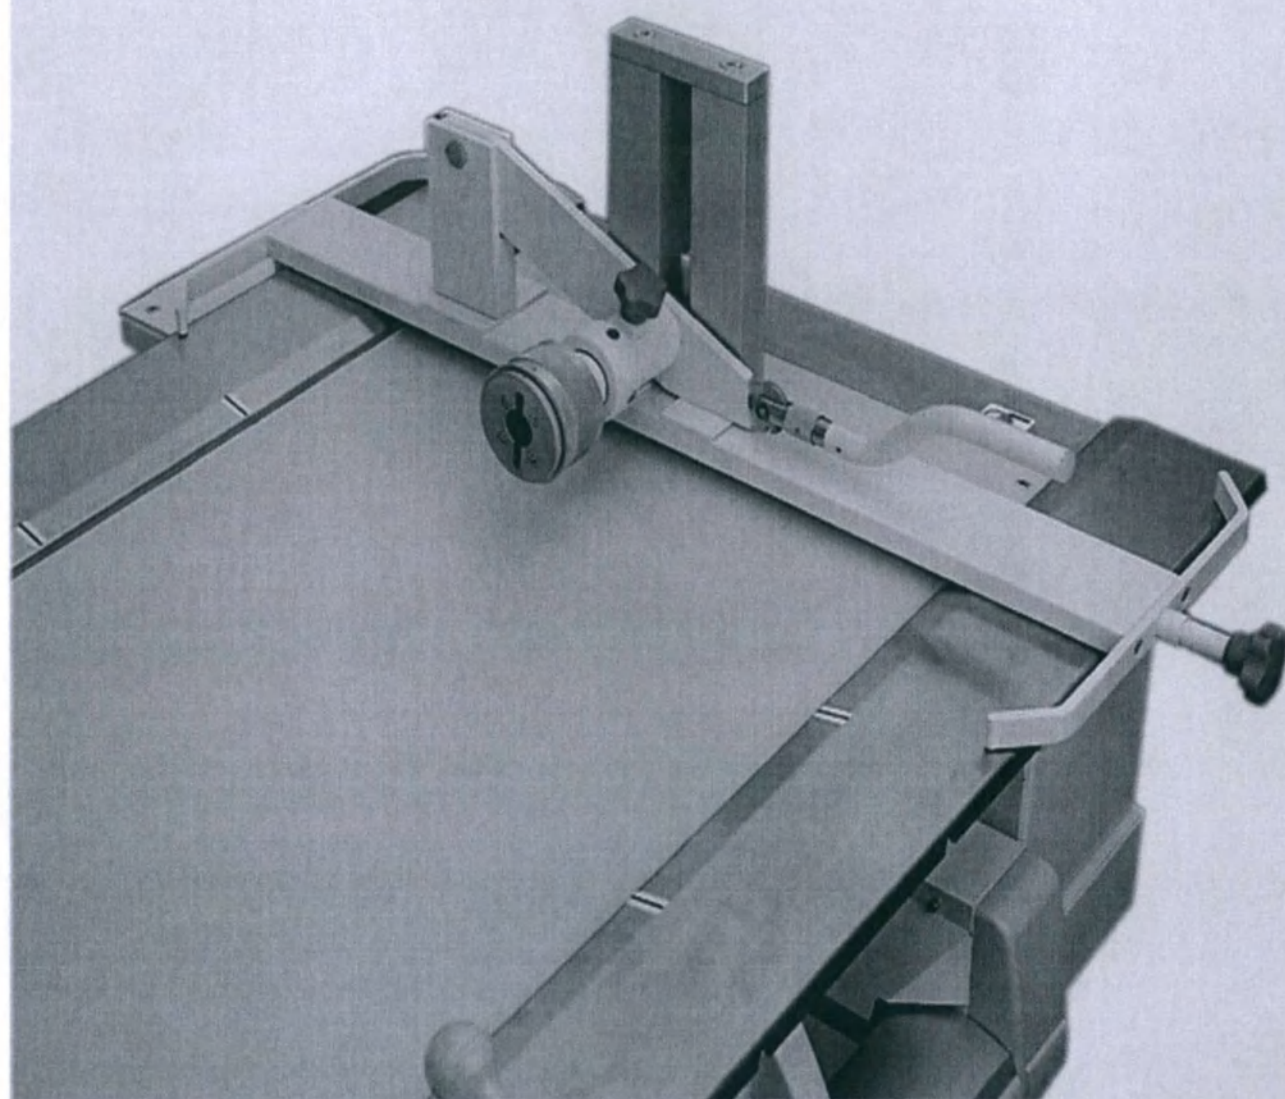

67. Ручной держатель для педиатрической люльки.

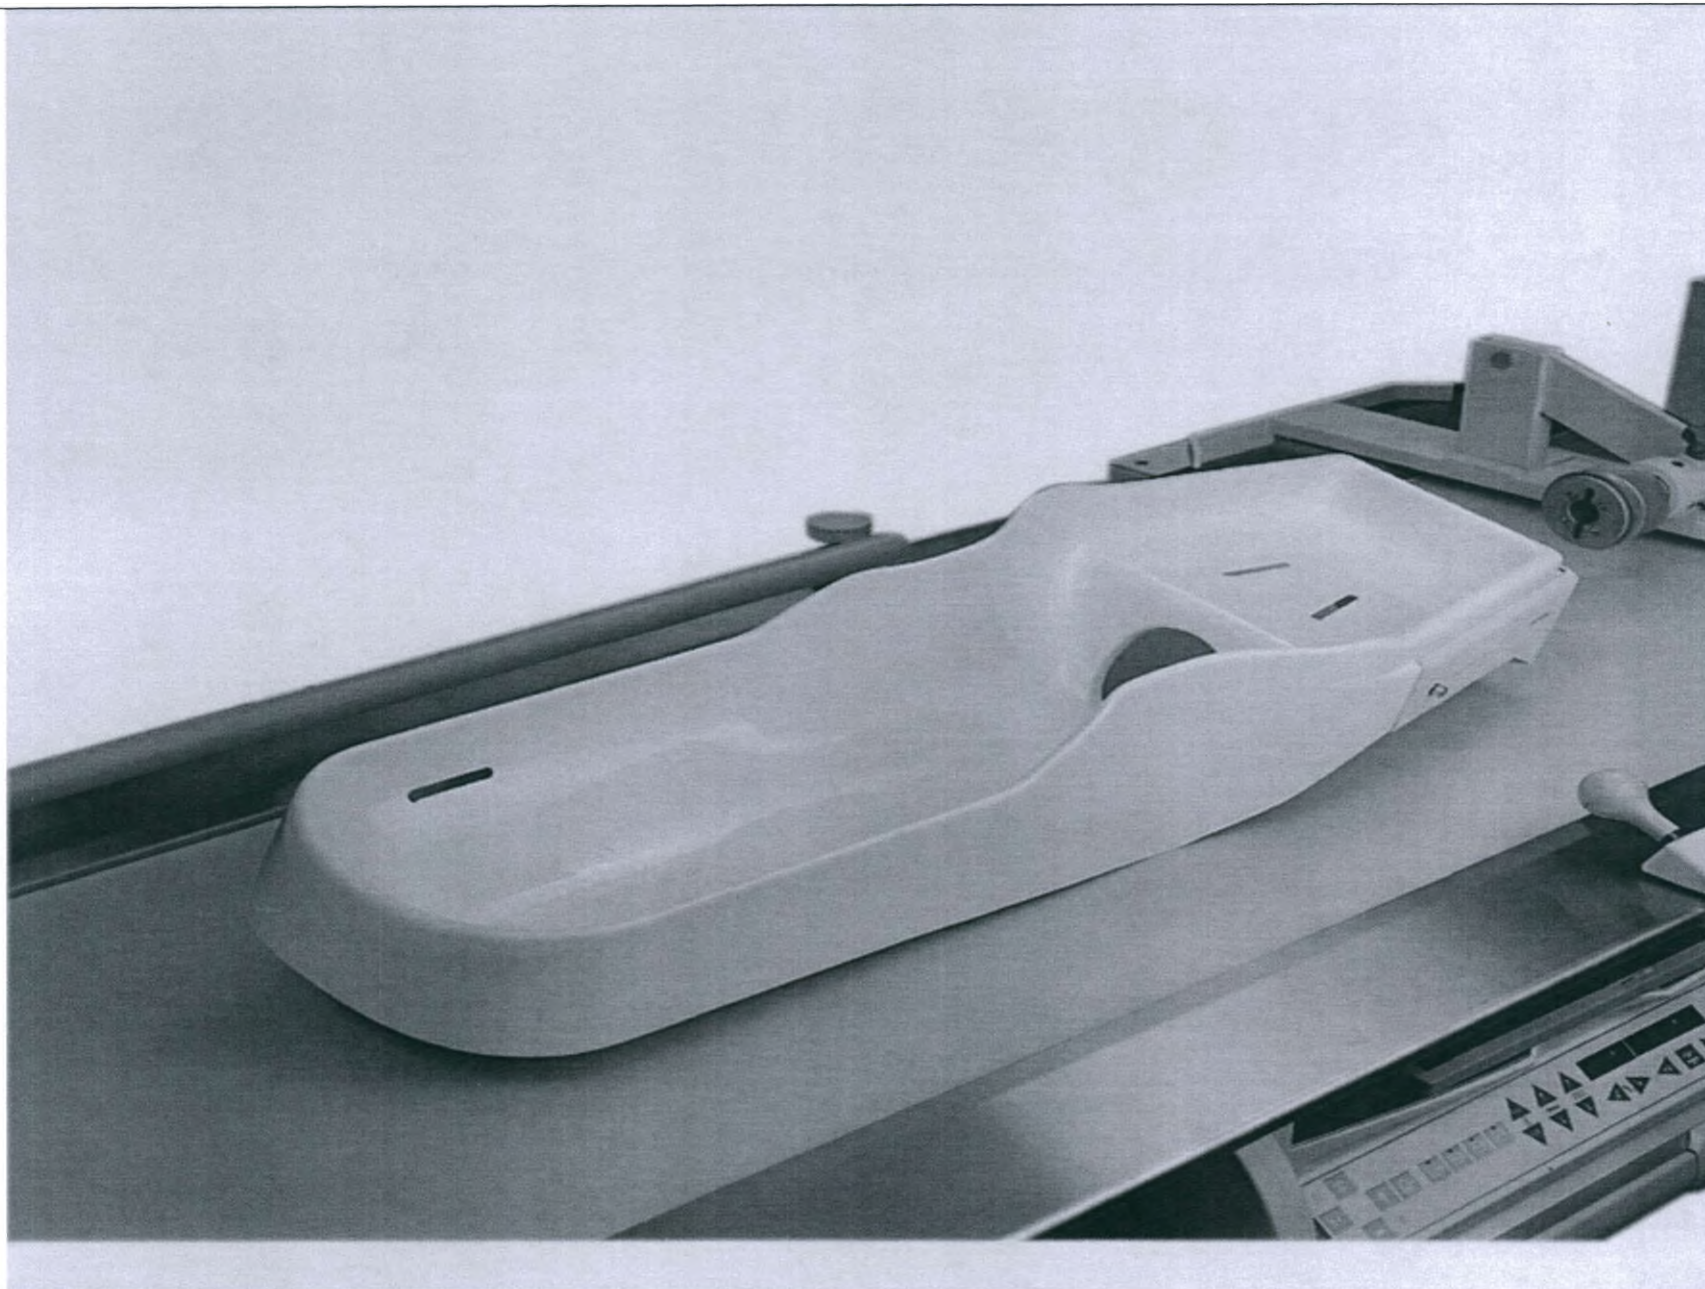


68. Люльки с лентами – липучками

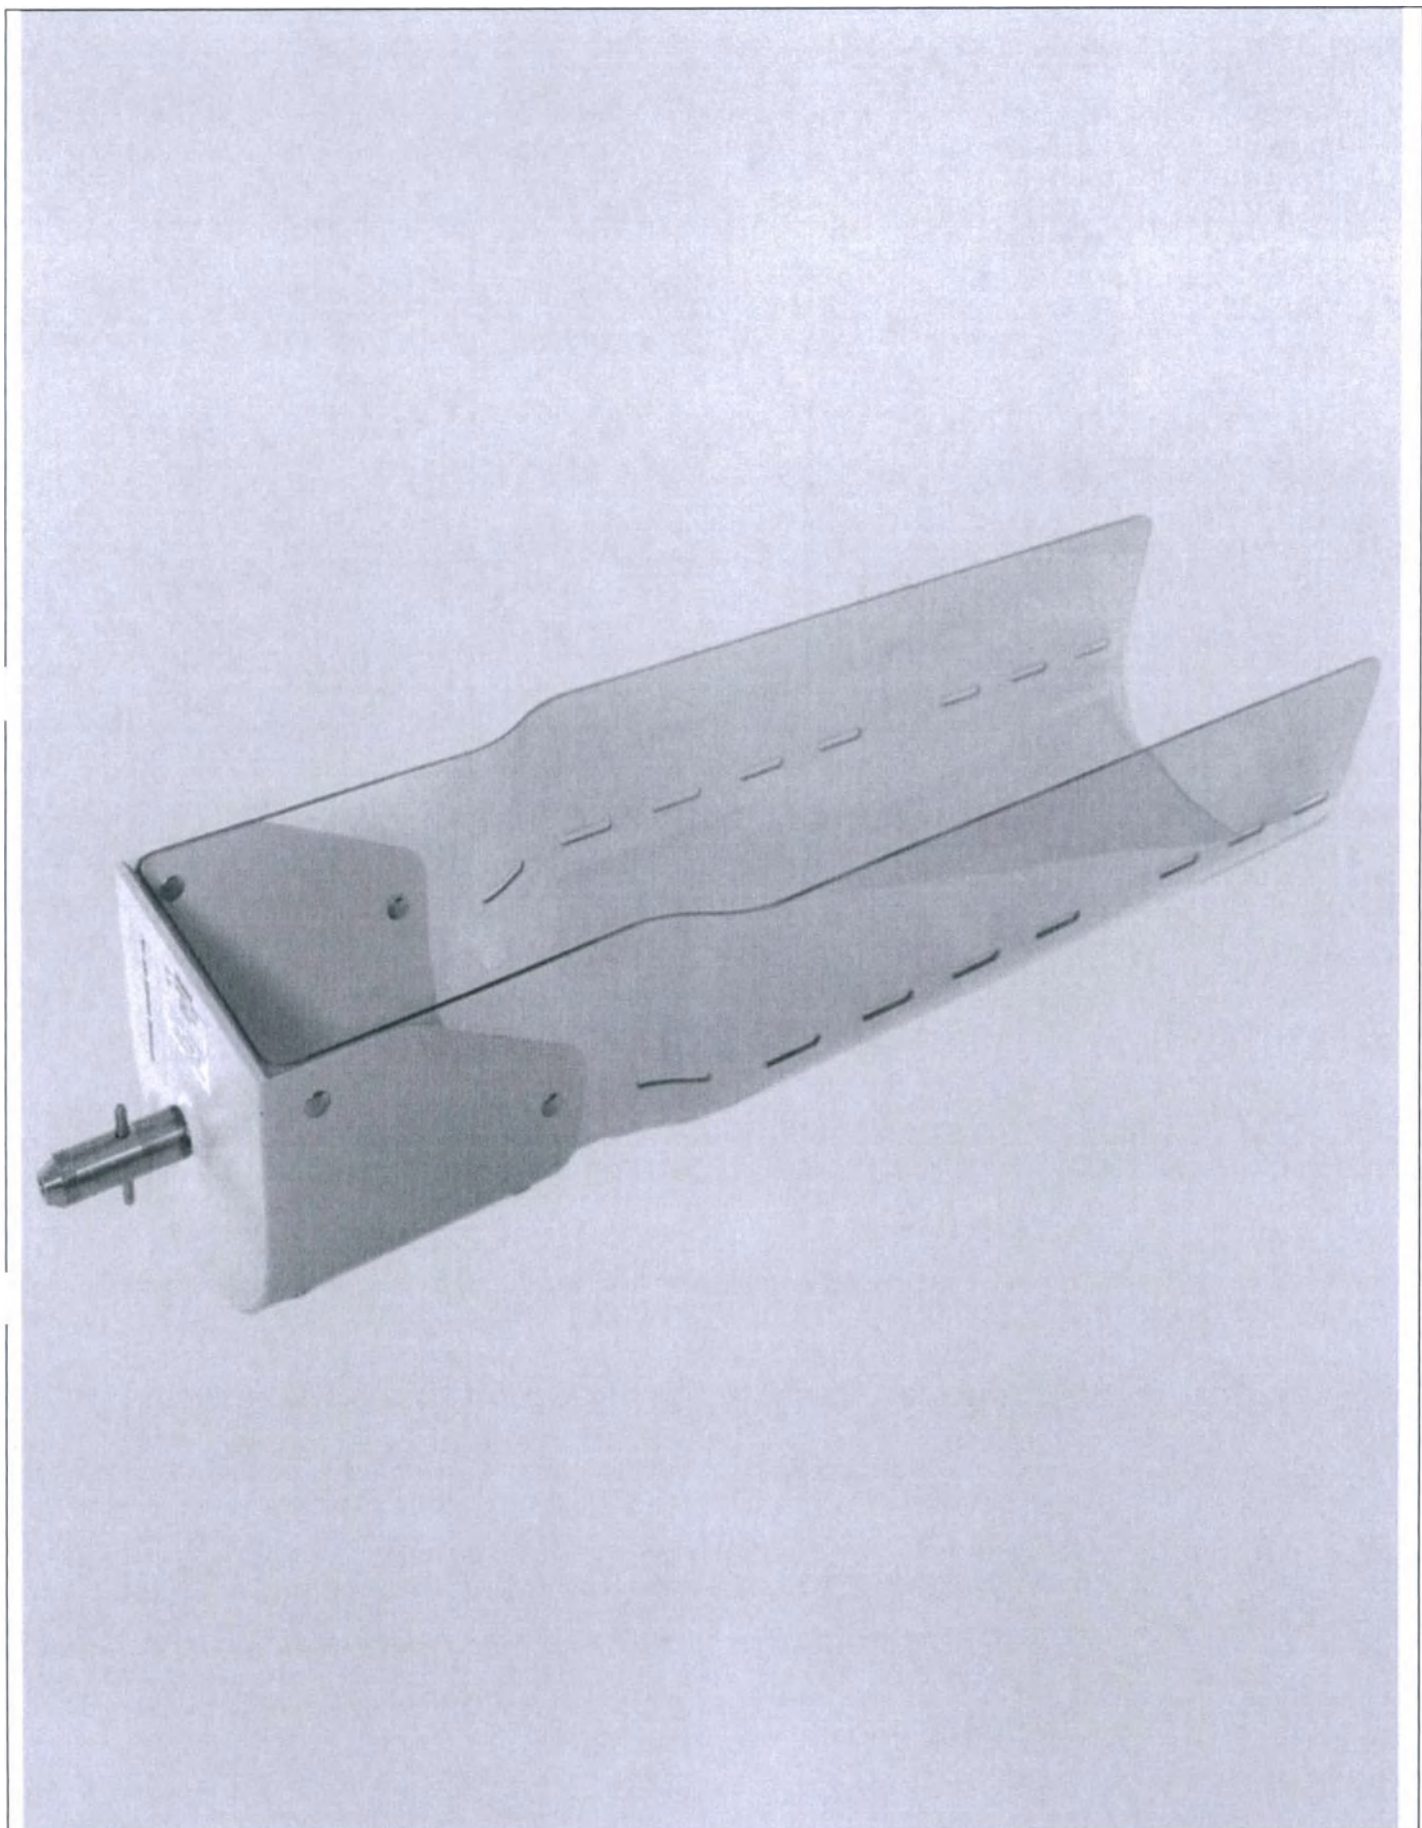


69. Люльки.




70. Держатель детской люльки для стола.

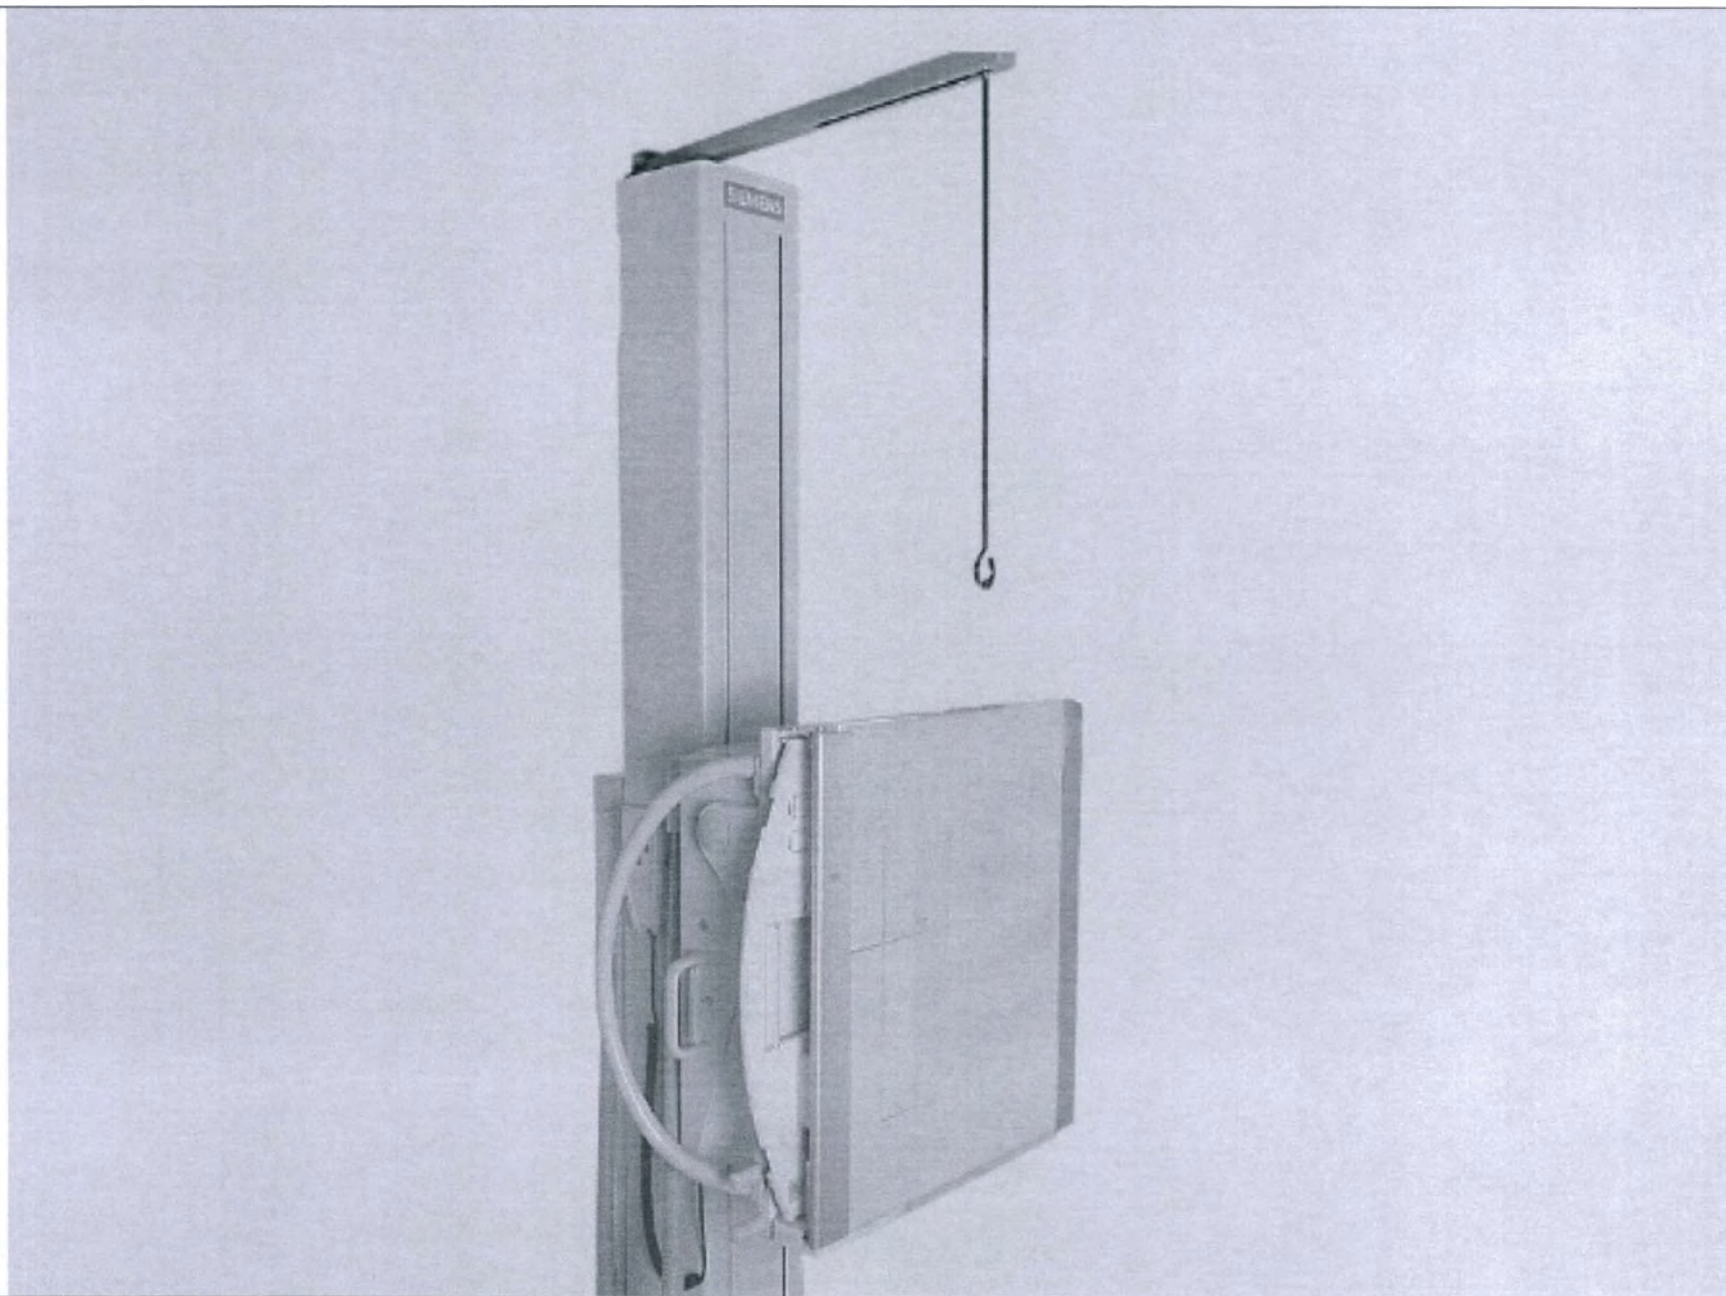


71. Держатель детской люльки для вертикальной стойки.

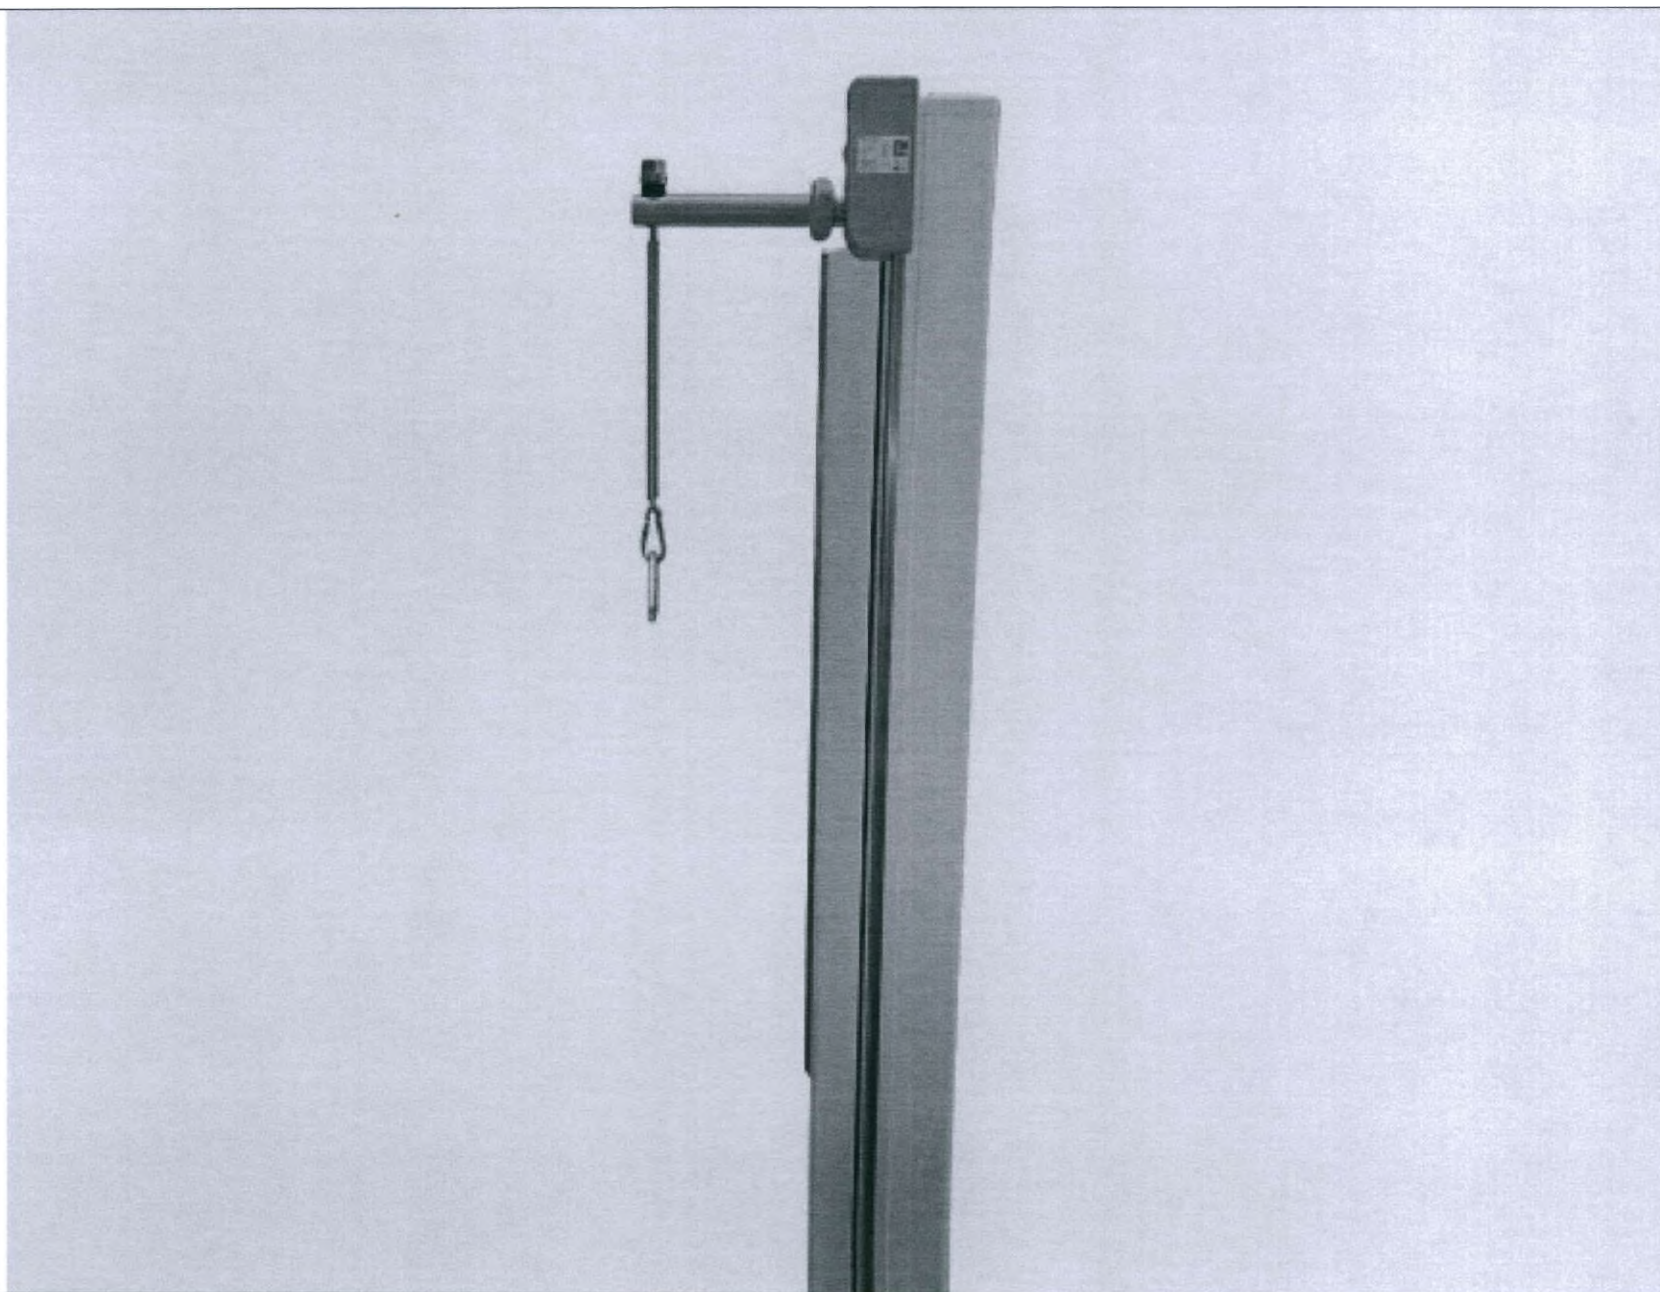


72. Держатель детской люльки для стойки Ortho.

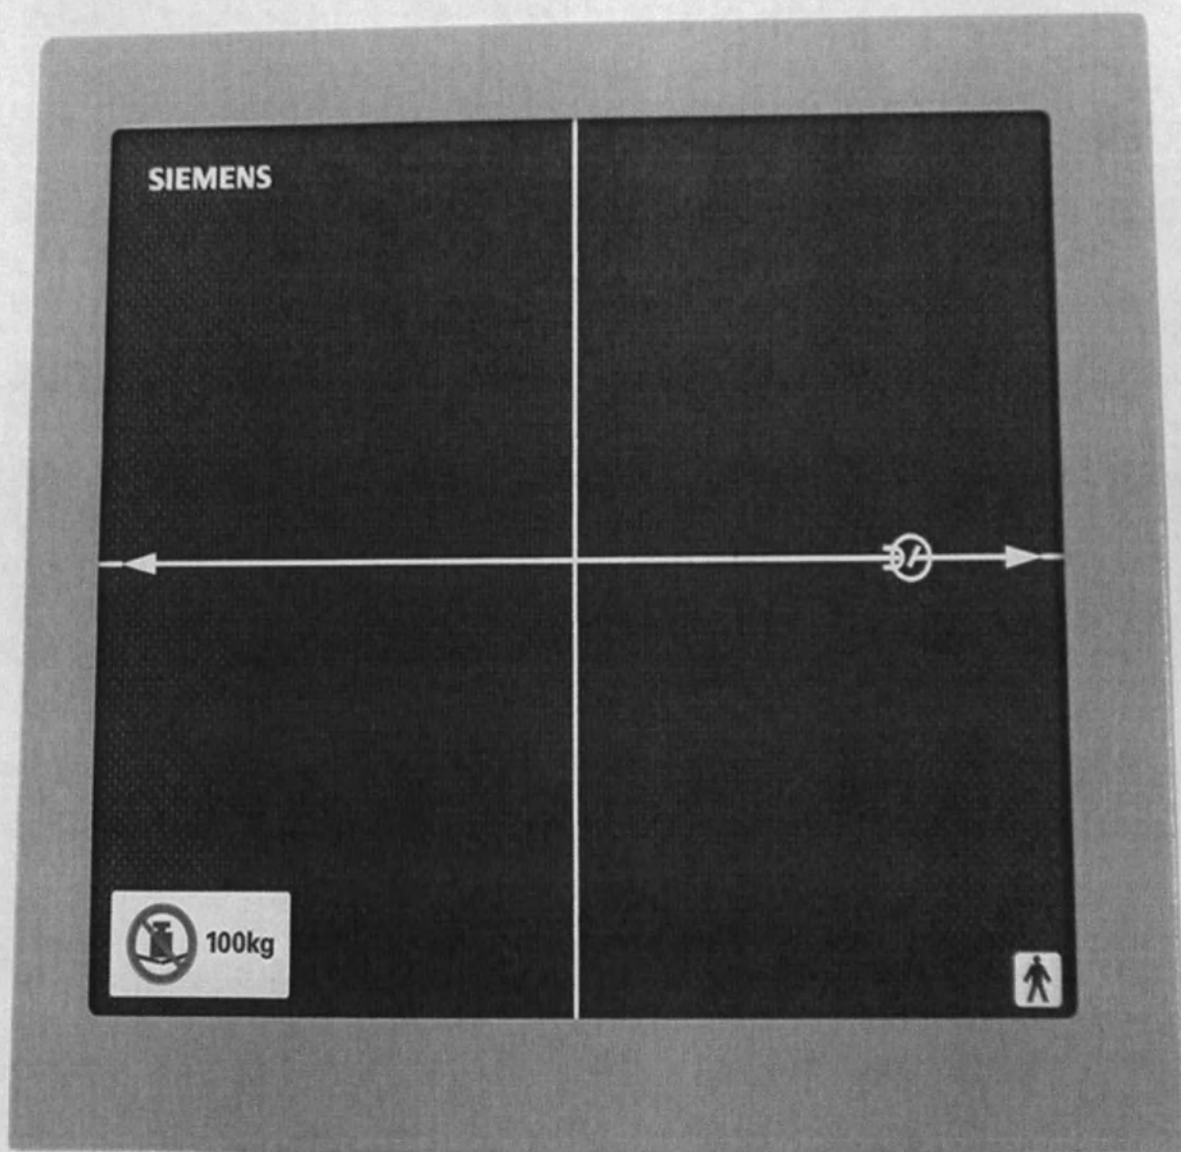


73. Решетка отсеивающая (13/92, F180)

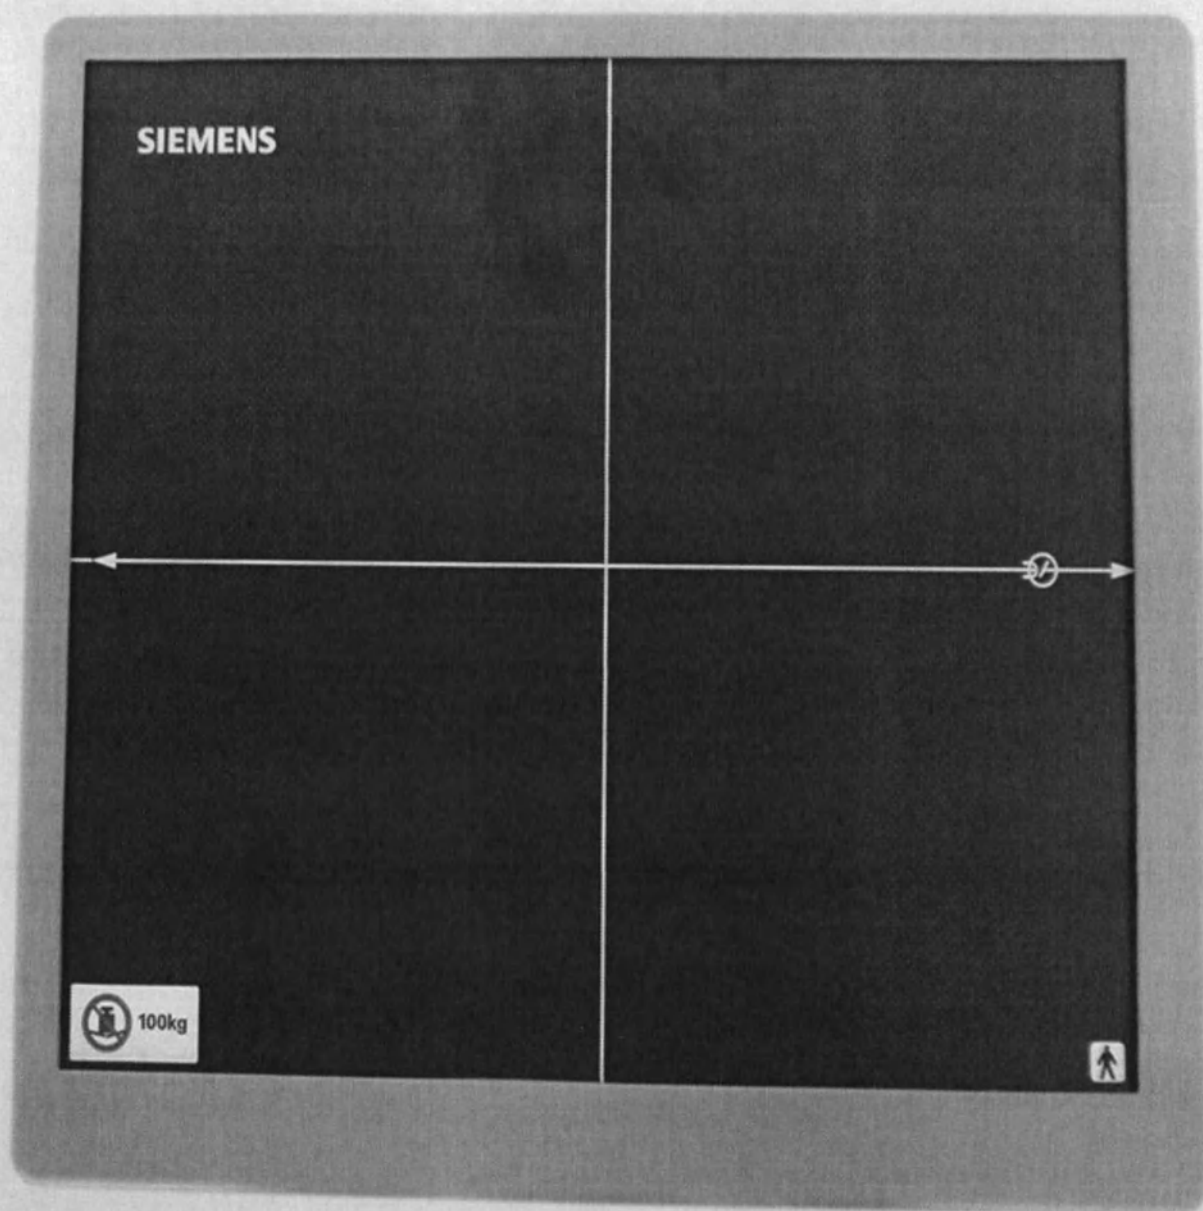


74. Решетка отсеивающая (15/80, F180)

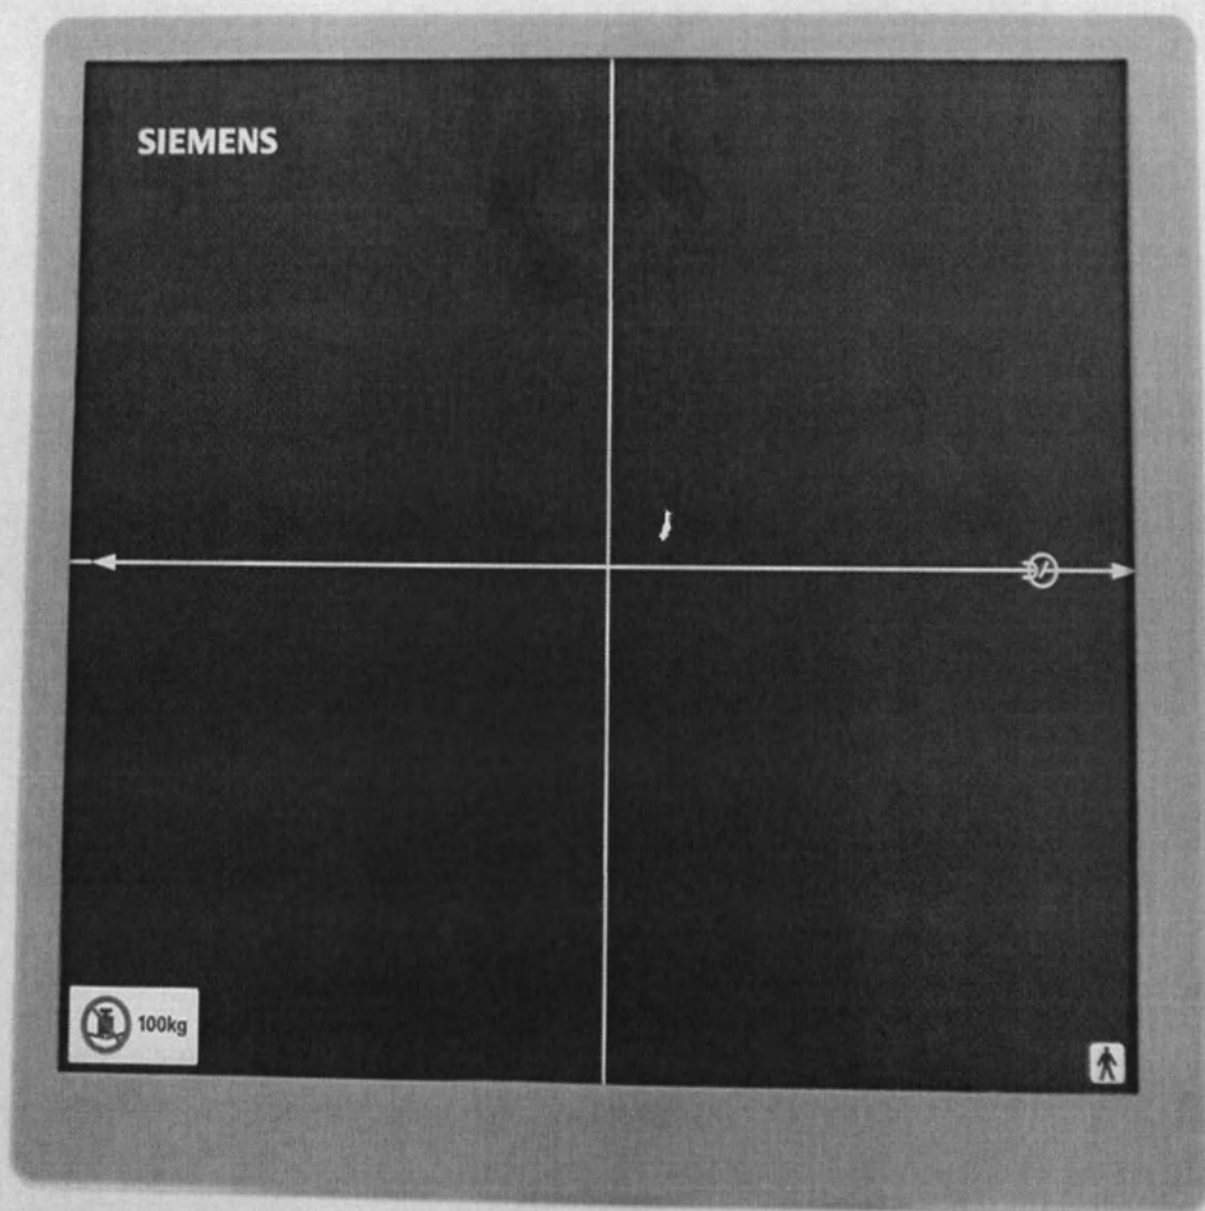


75. Решетка отсеивающая универсальная (13/92)

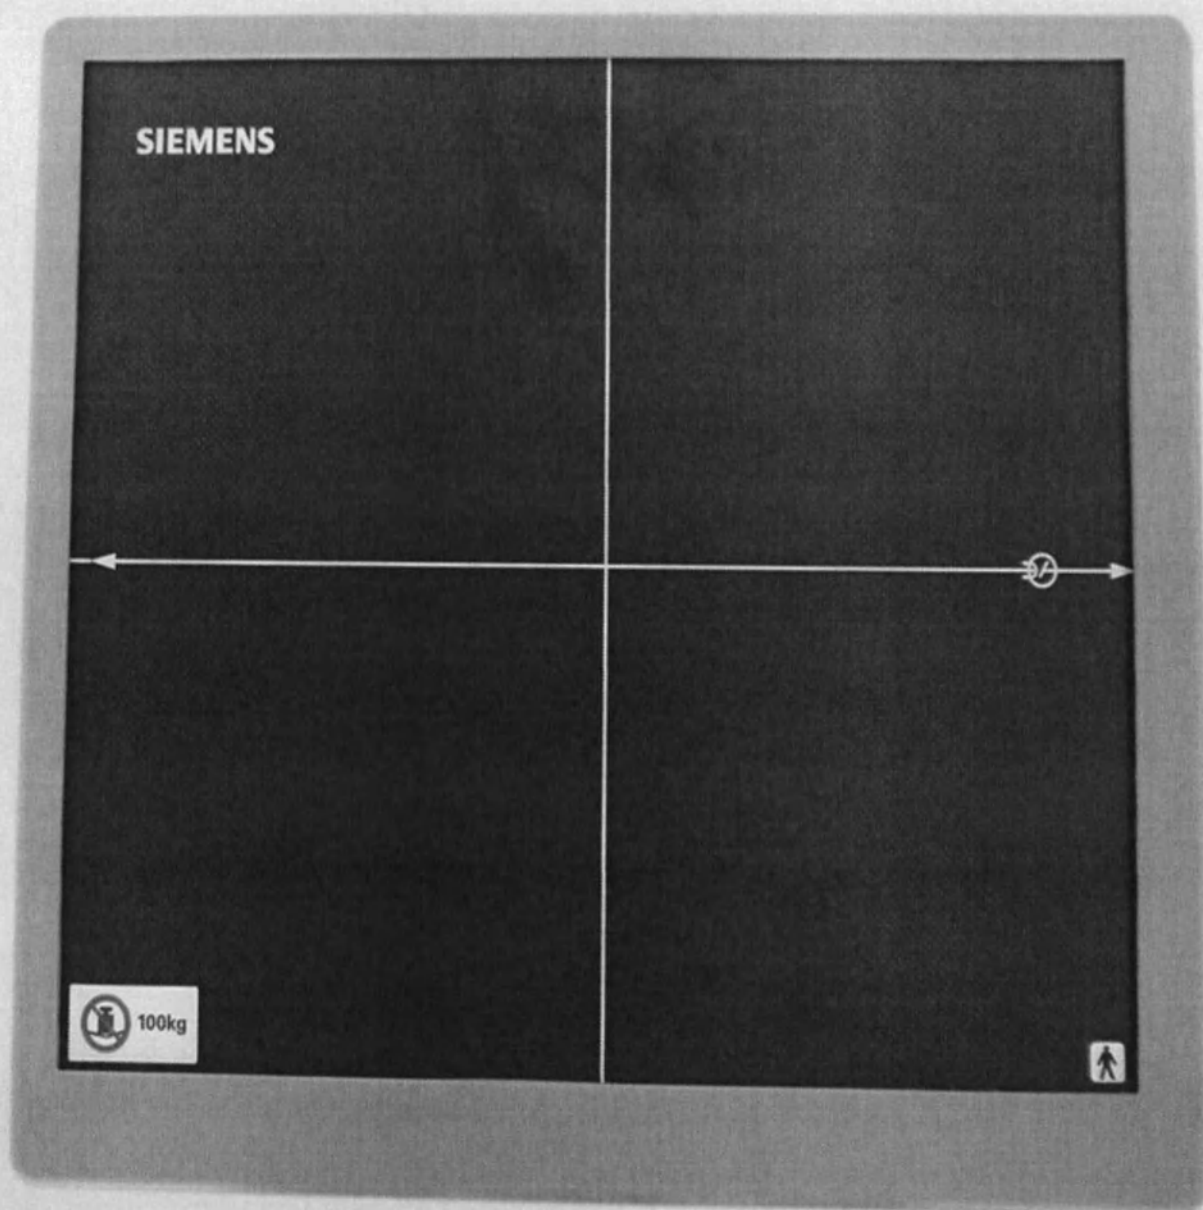


76. Решетка отсеивающая (13/92, F115)

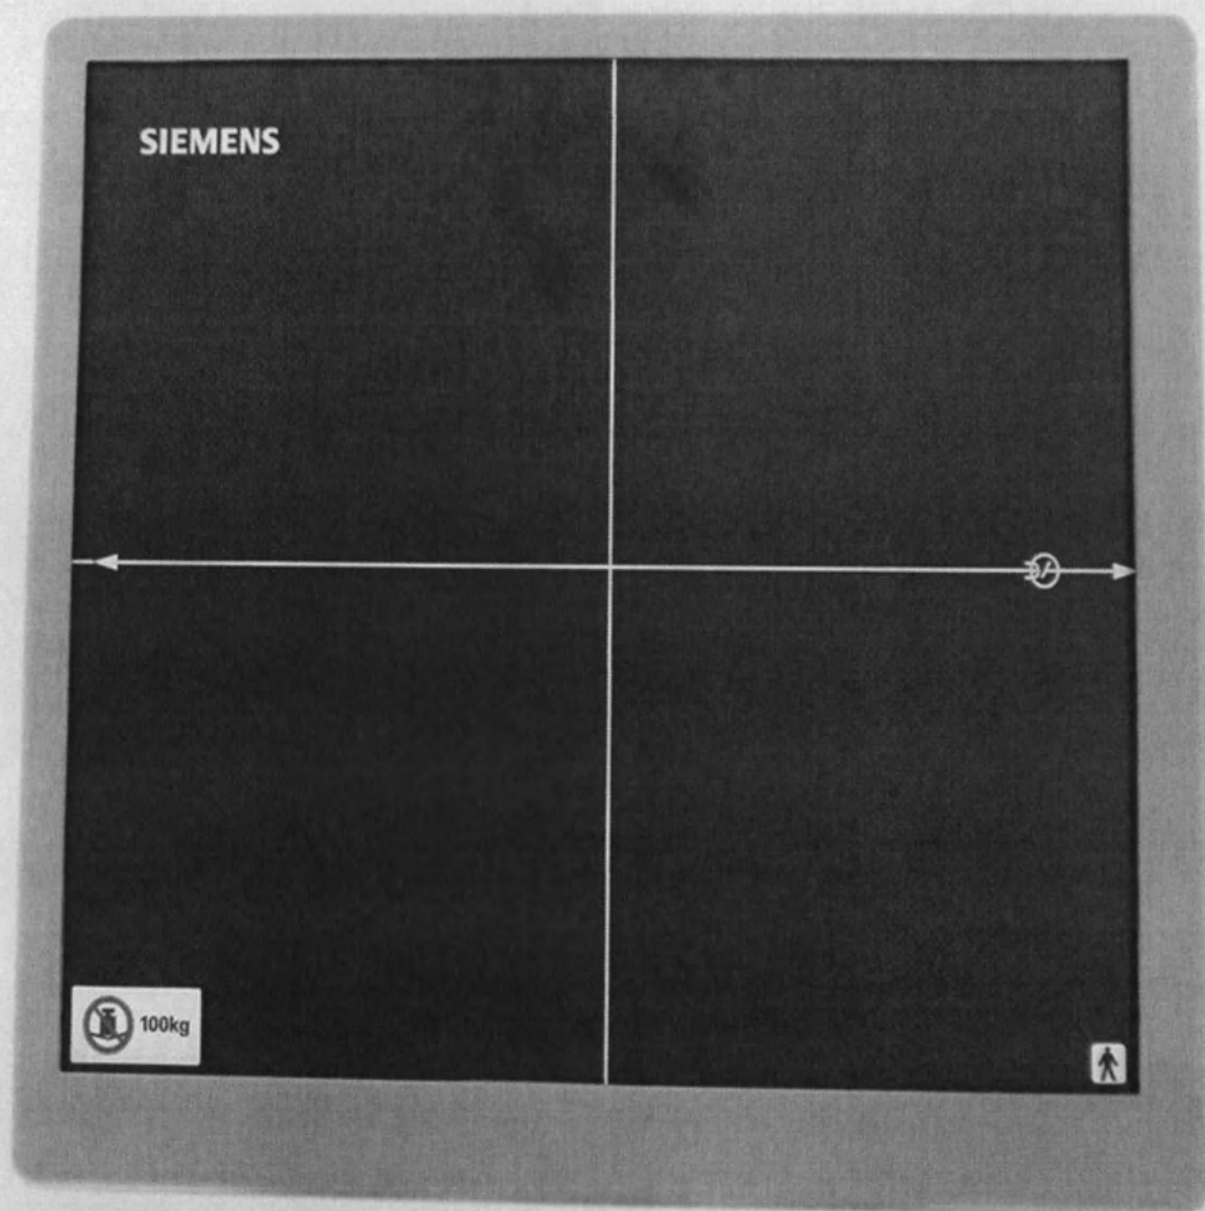


77. Решетка отсеивающая (15/80, F115)

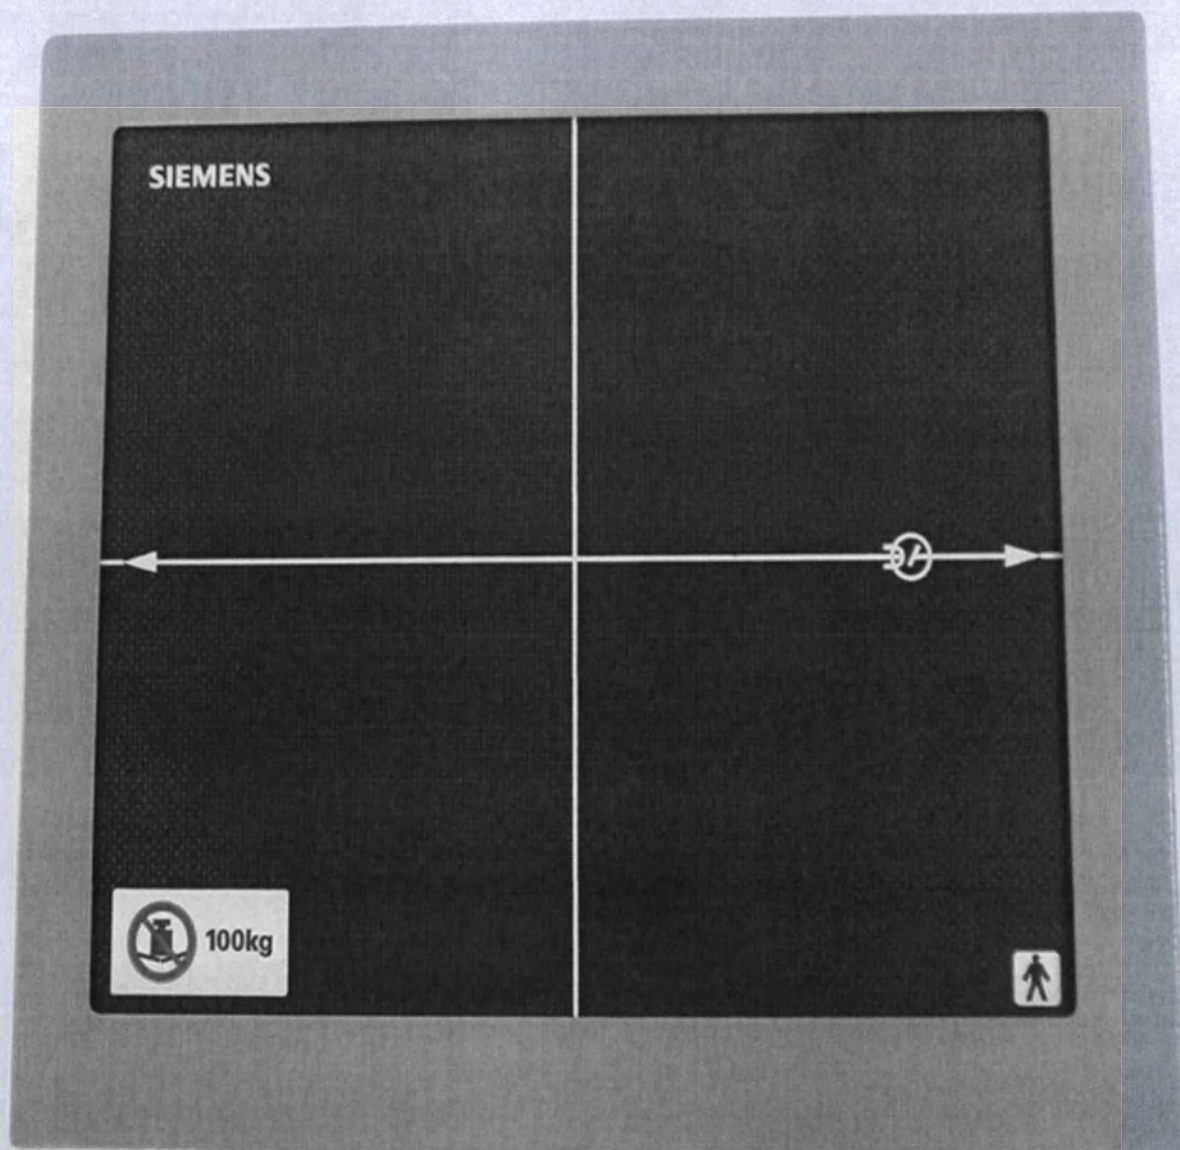


78. Решетка отсеивающая (15/80, F300)

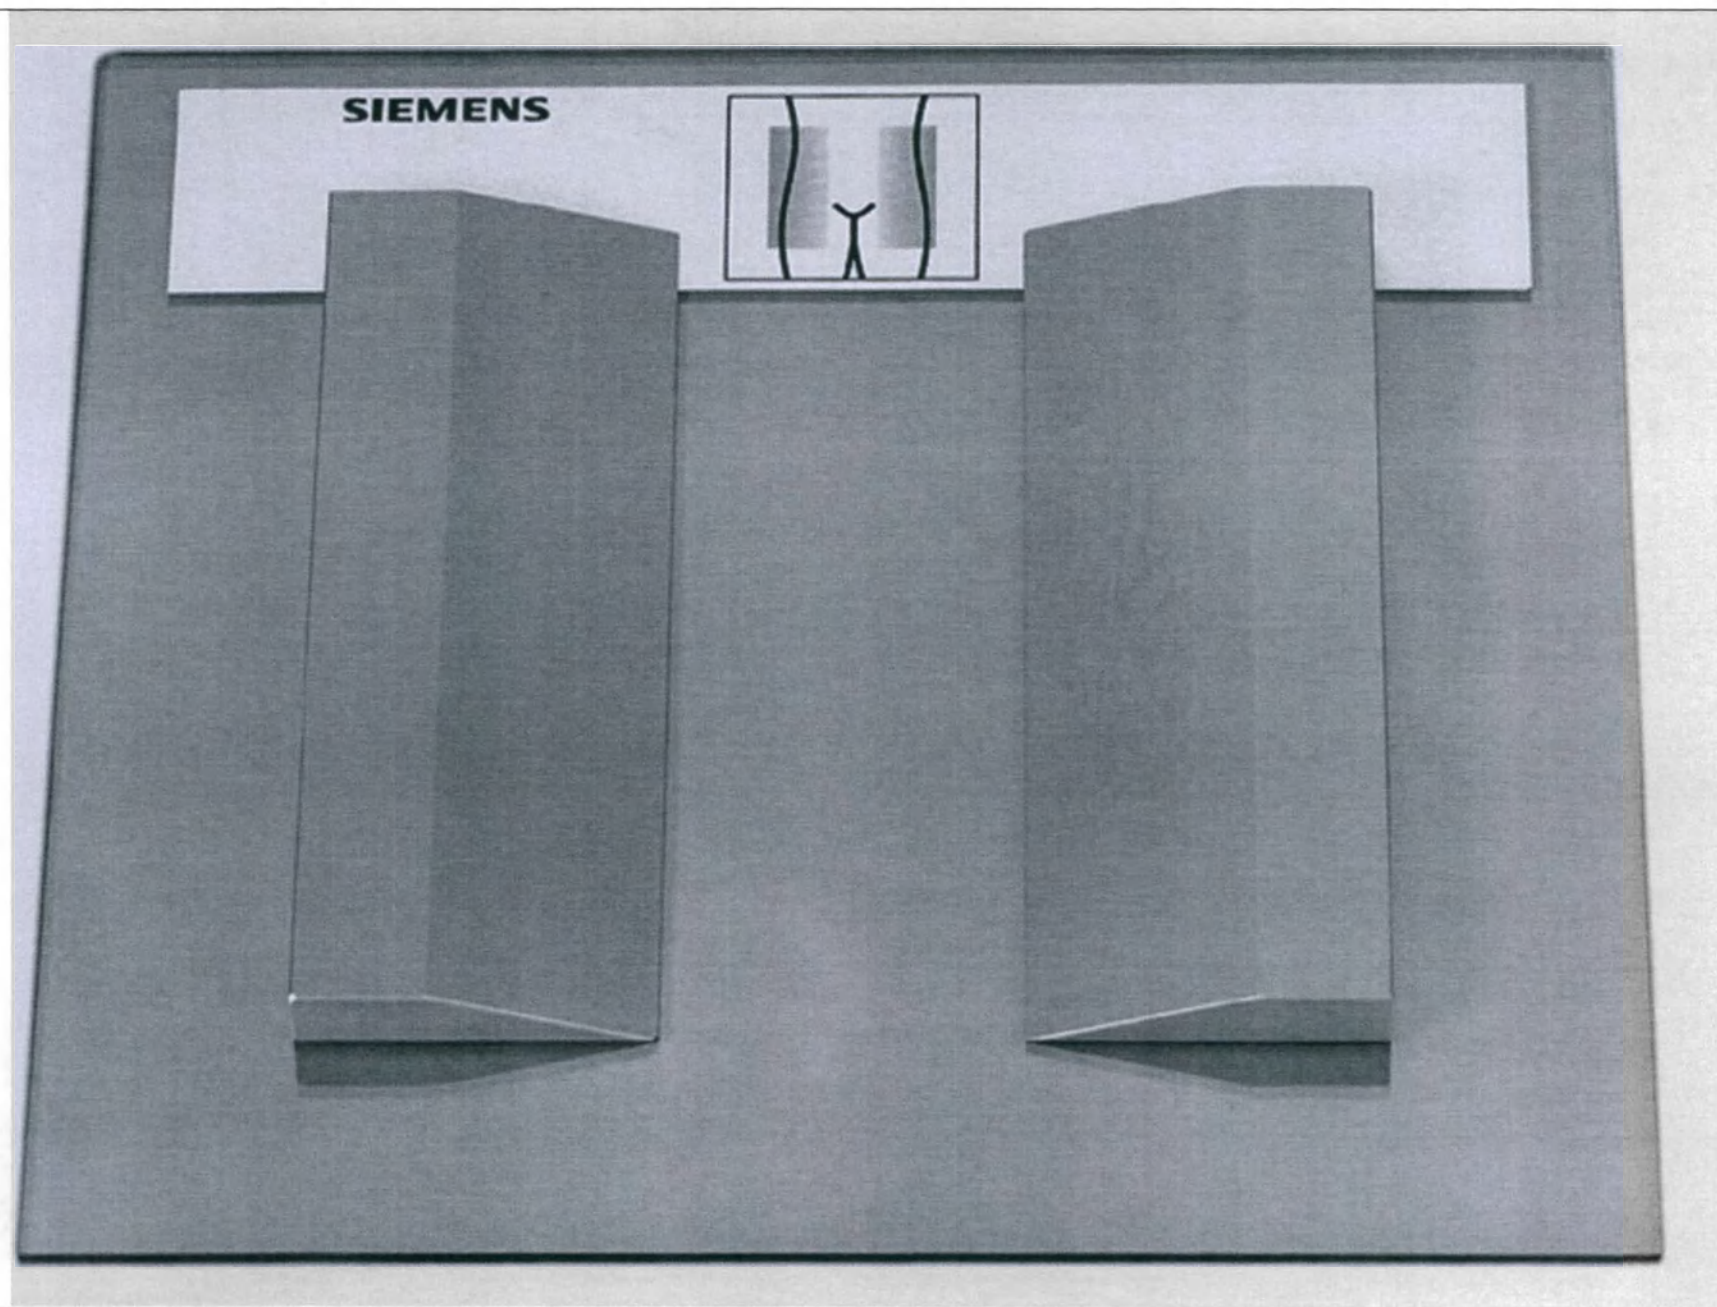


79. Компенсационный фильтр, таз.

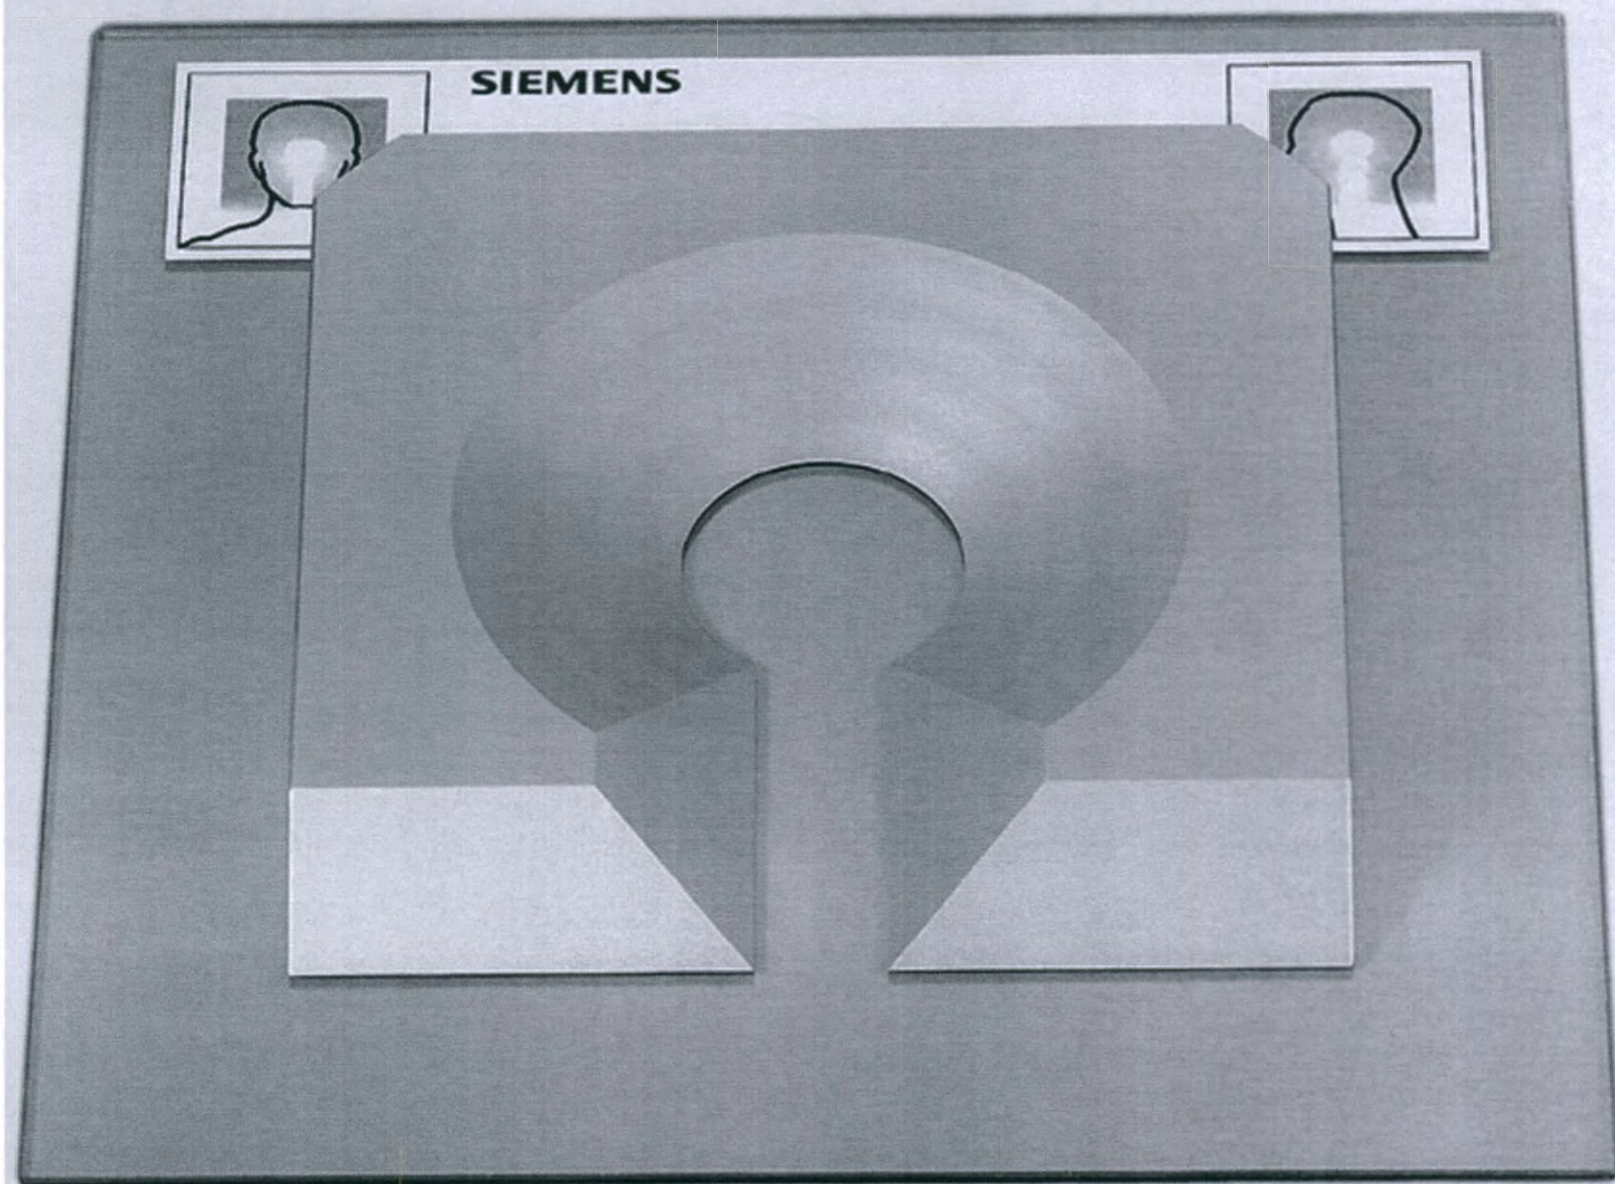


80. Компенсационный фильтр, череп взрослого.

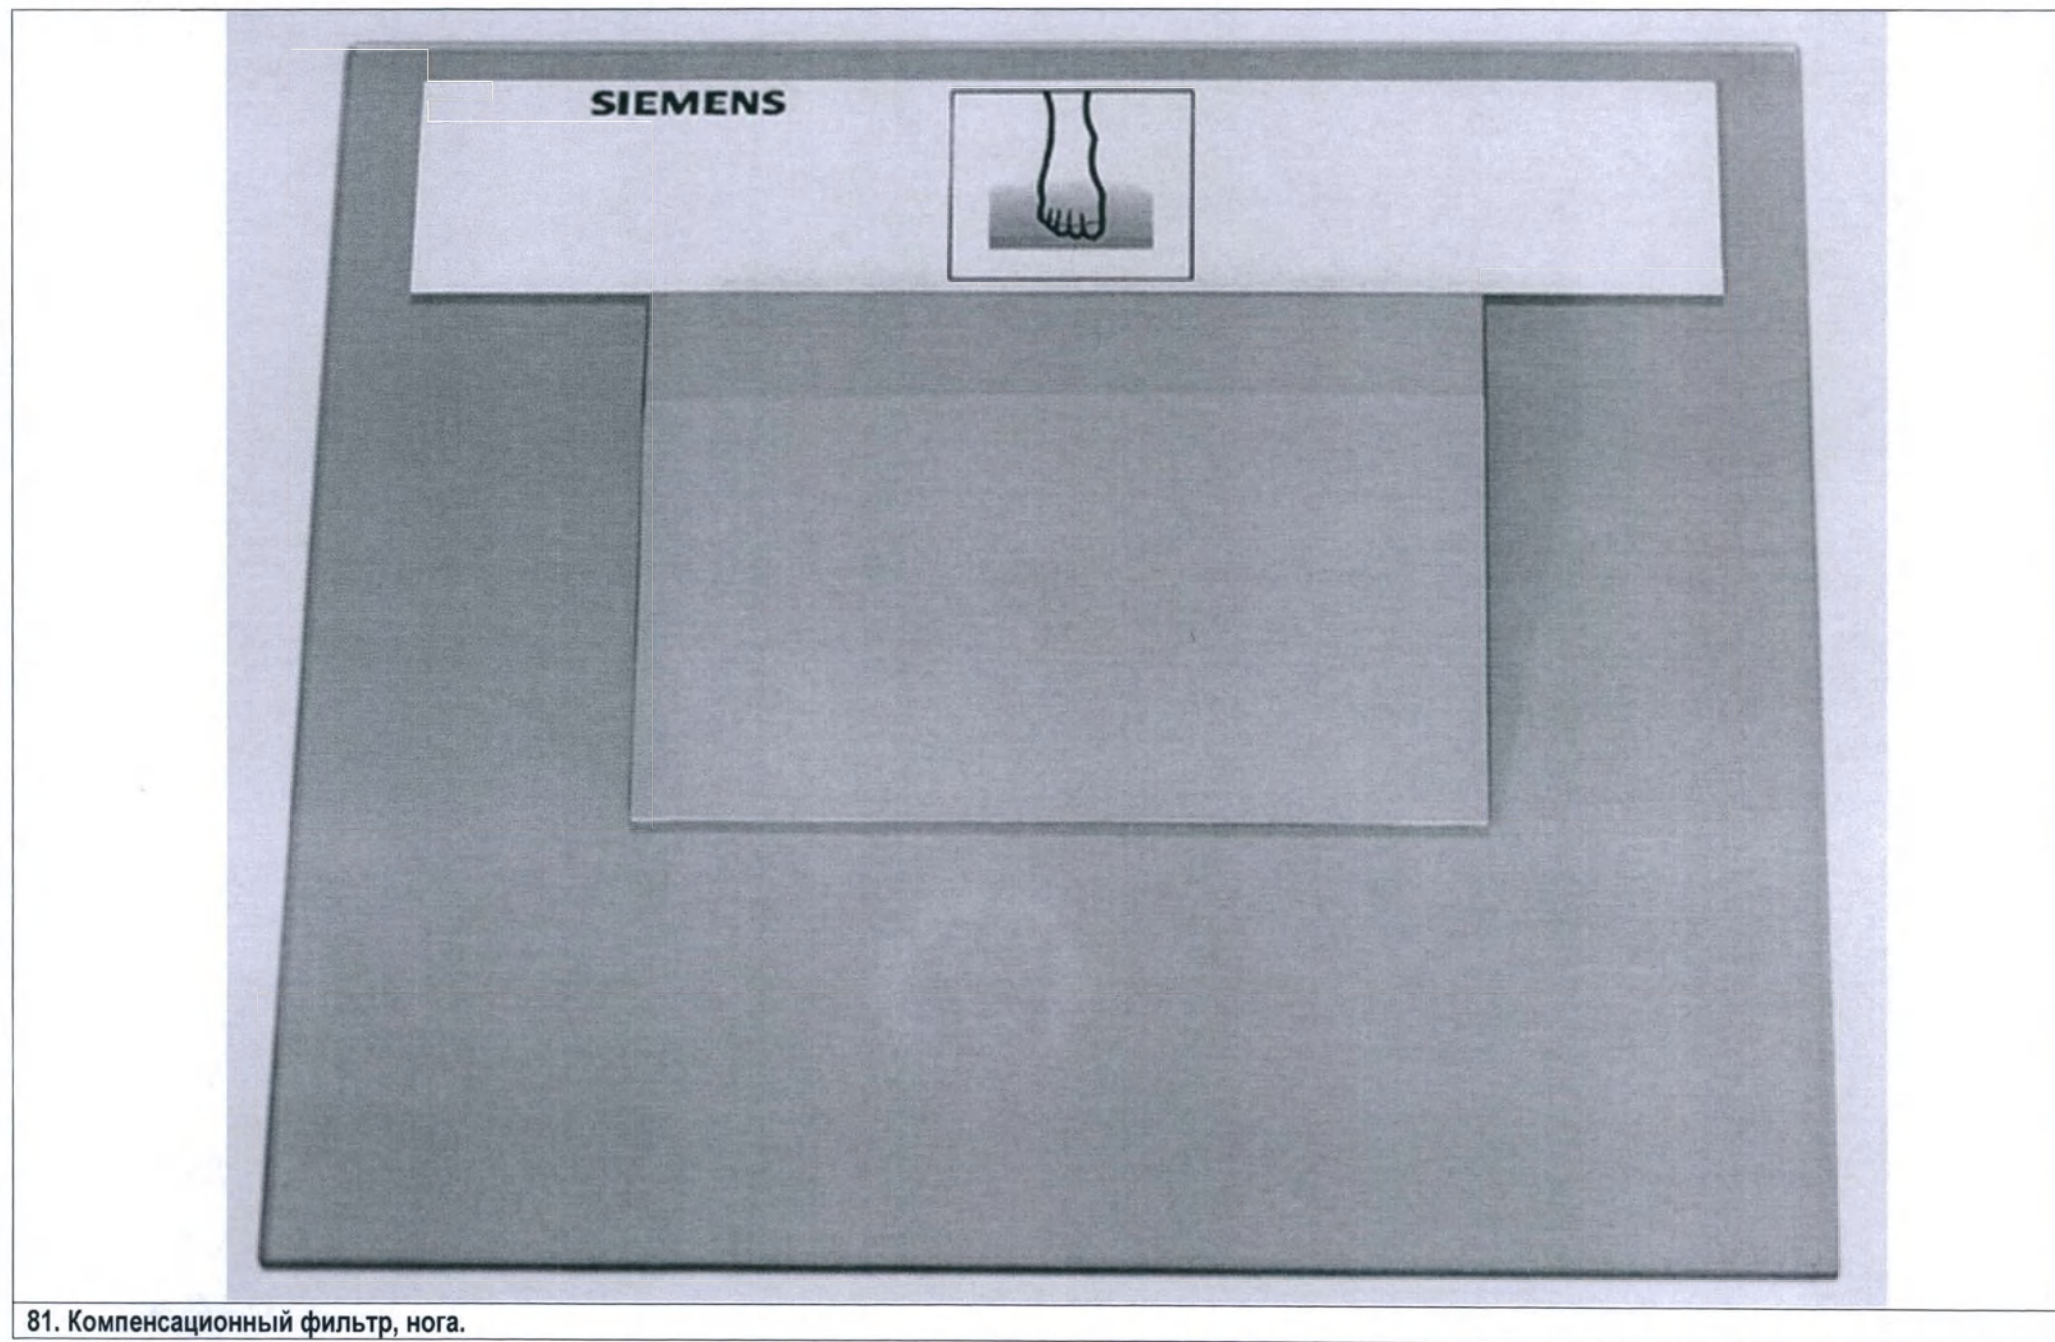


81. Компенсационный фильтр, нога.

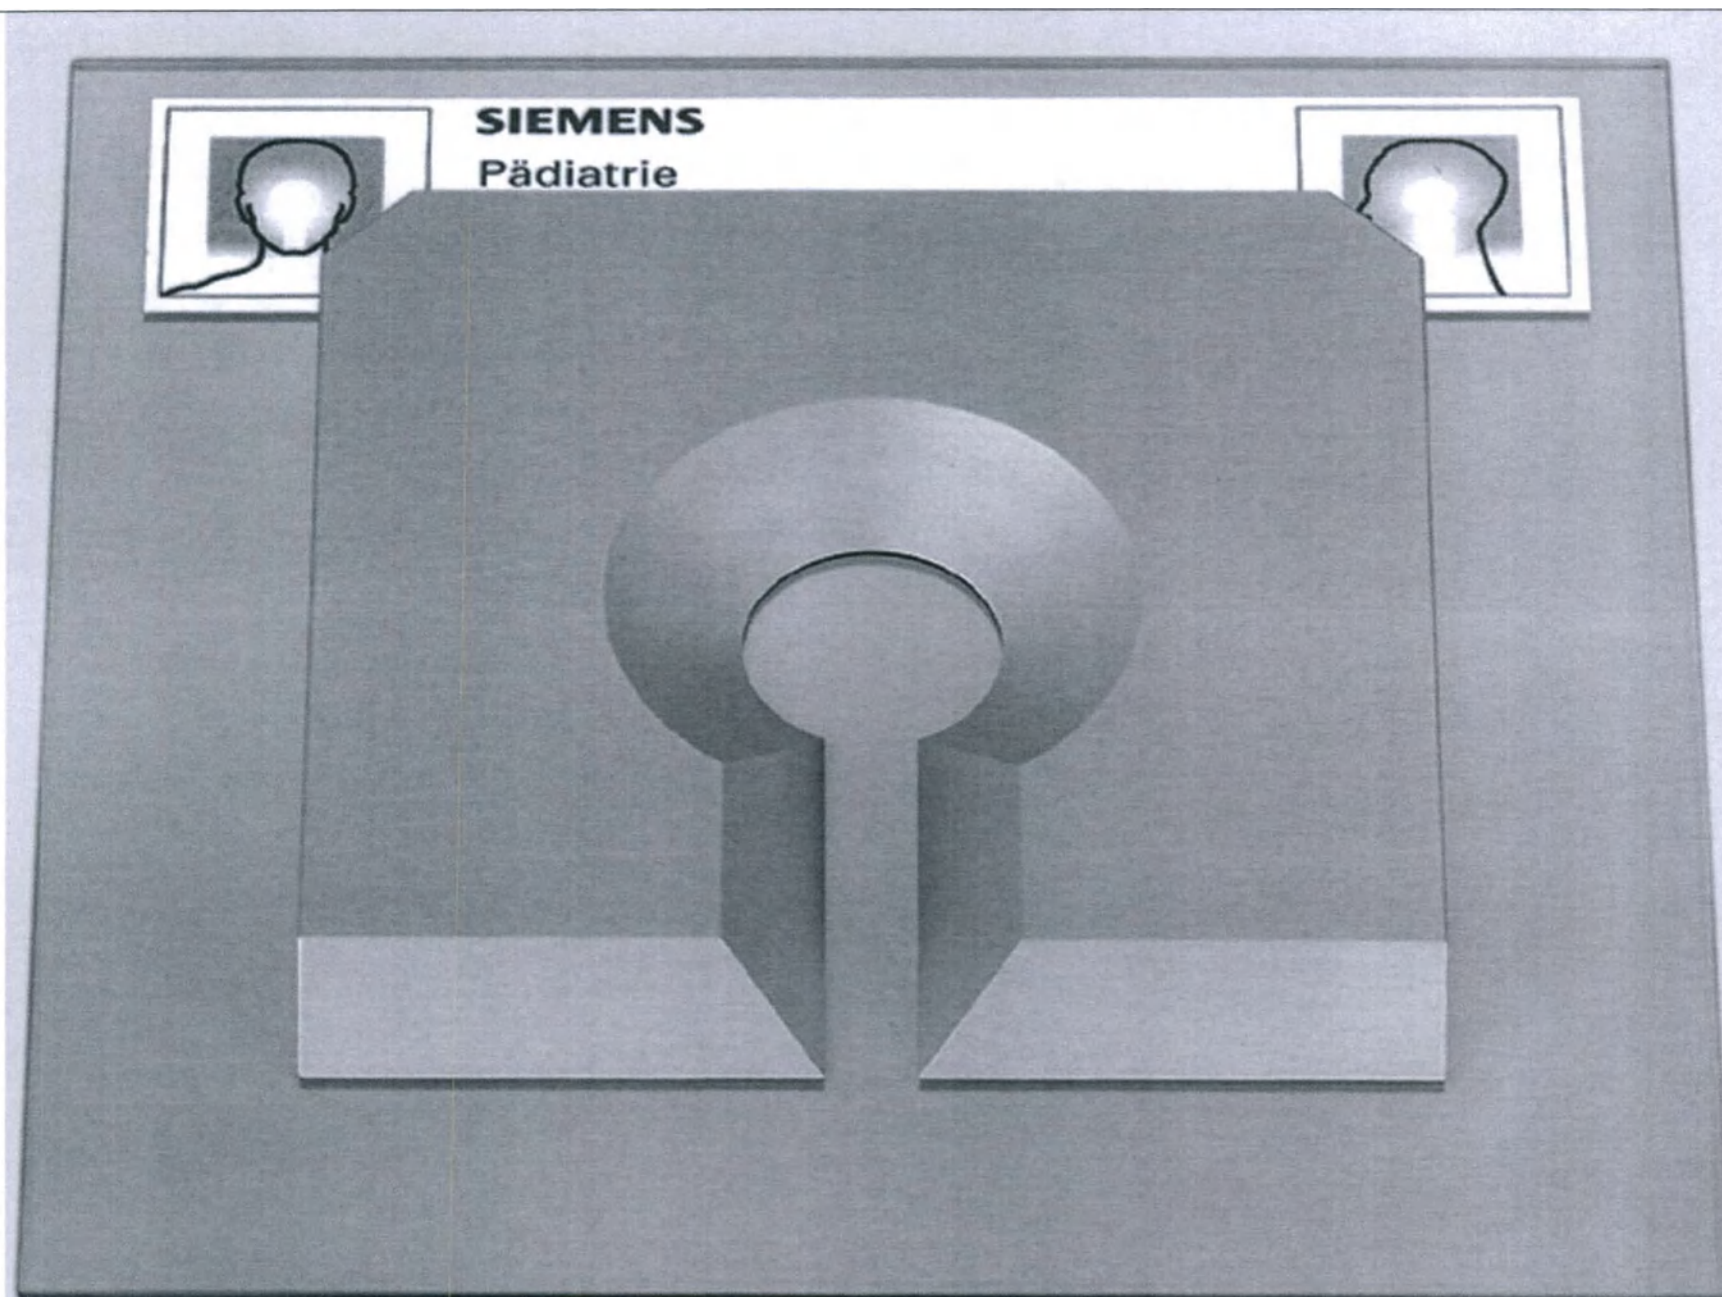


82. Компенсационный фильтр, череп ребенка.

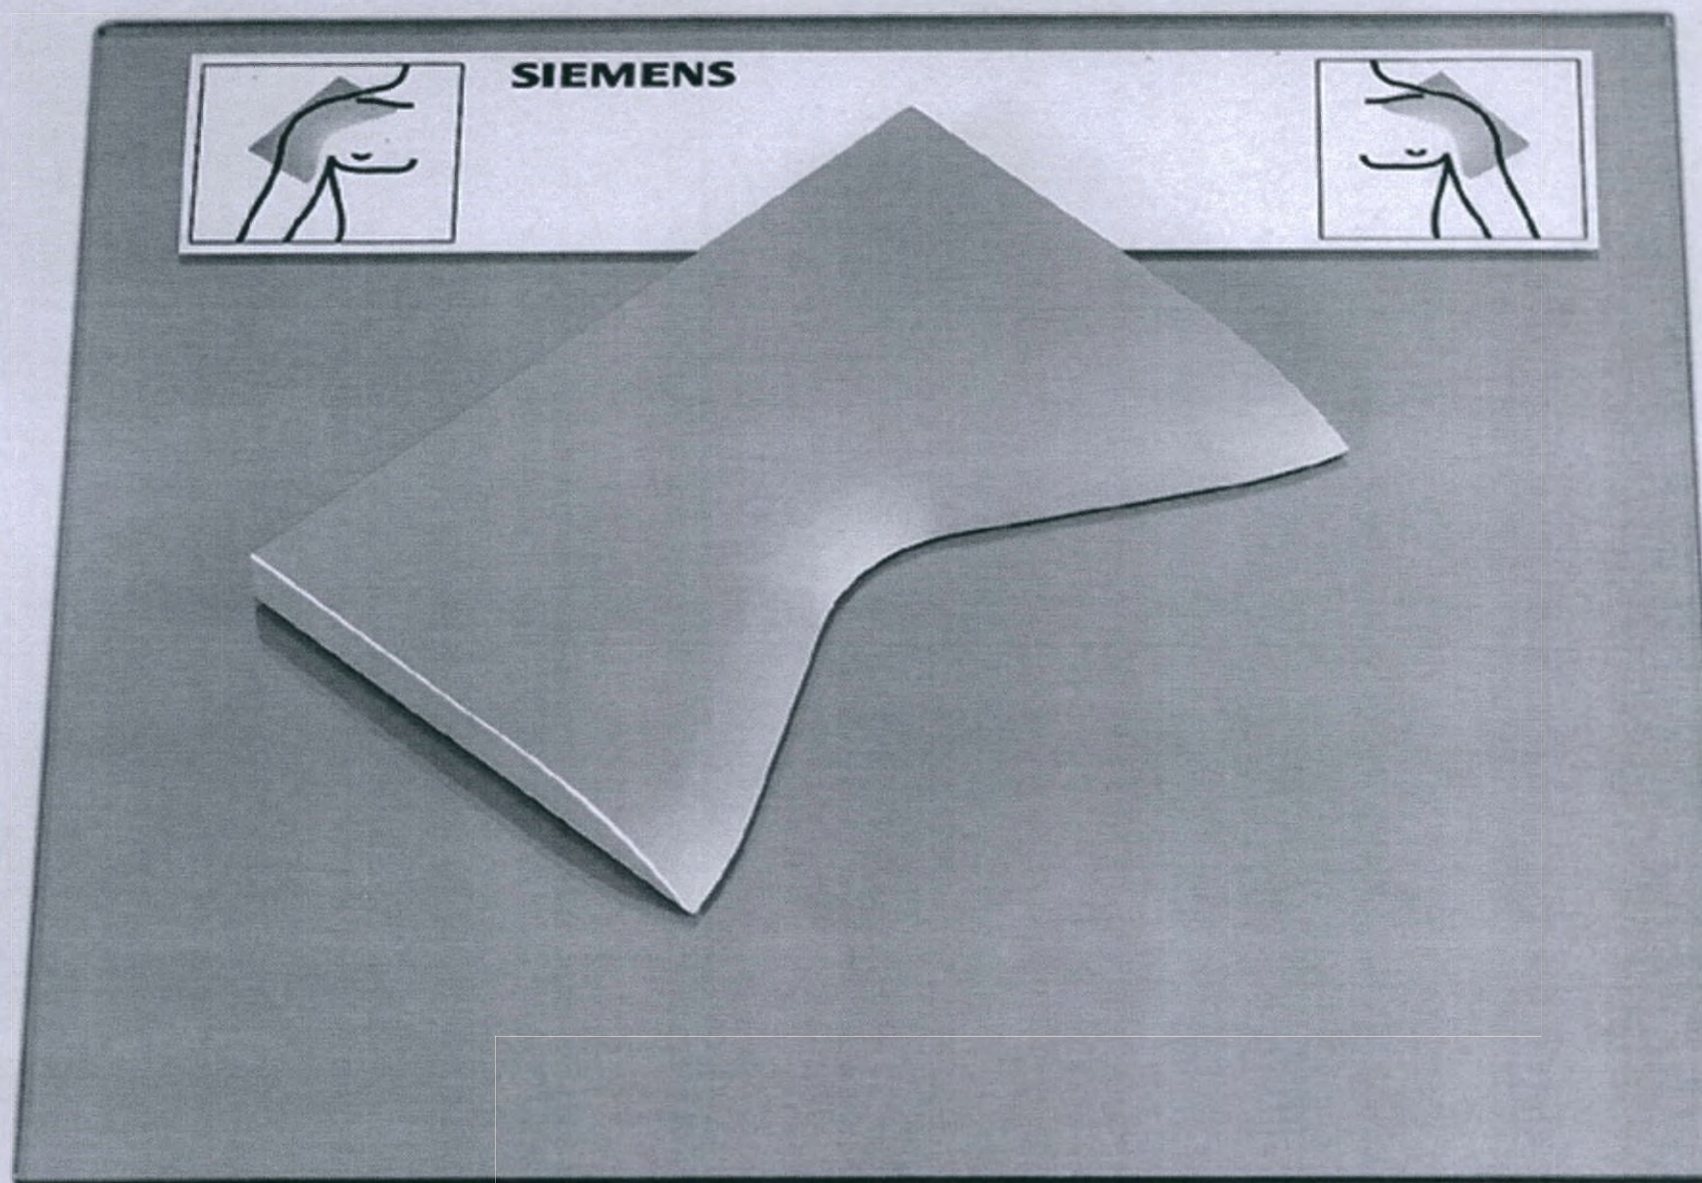


83. Компенсационный фильтр, плечо.

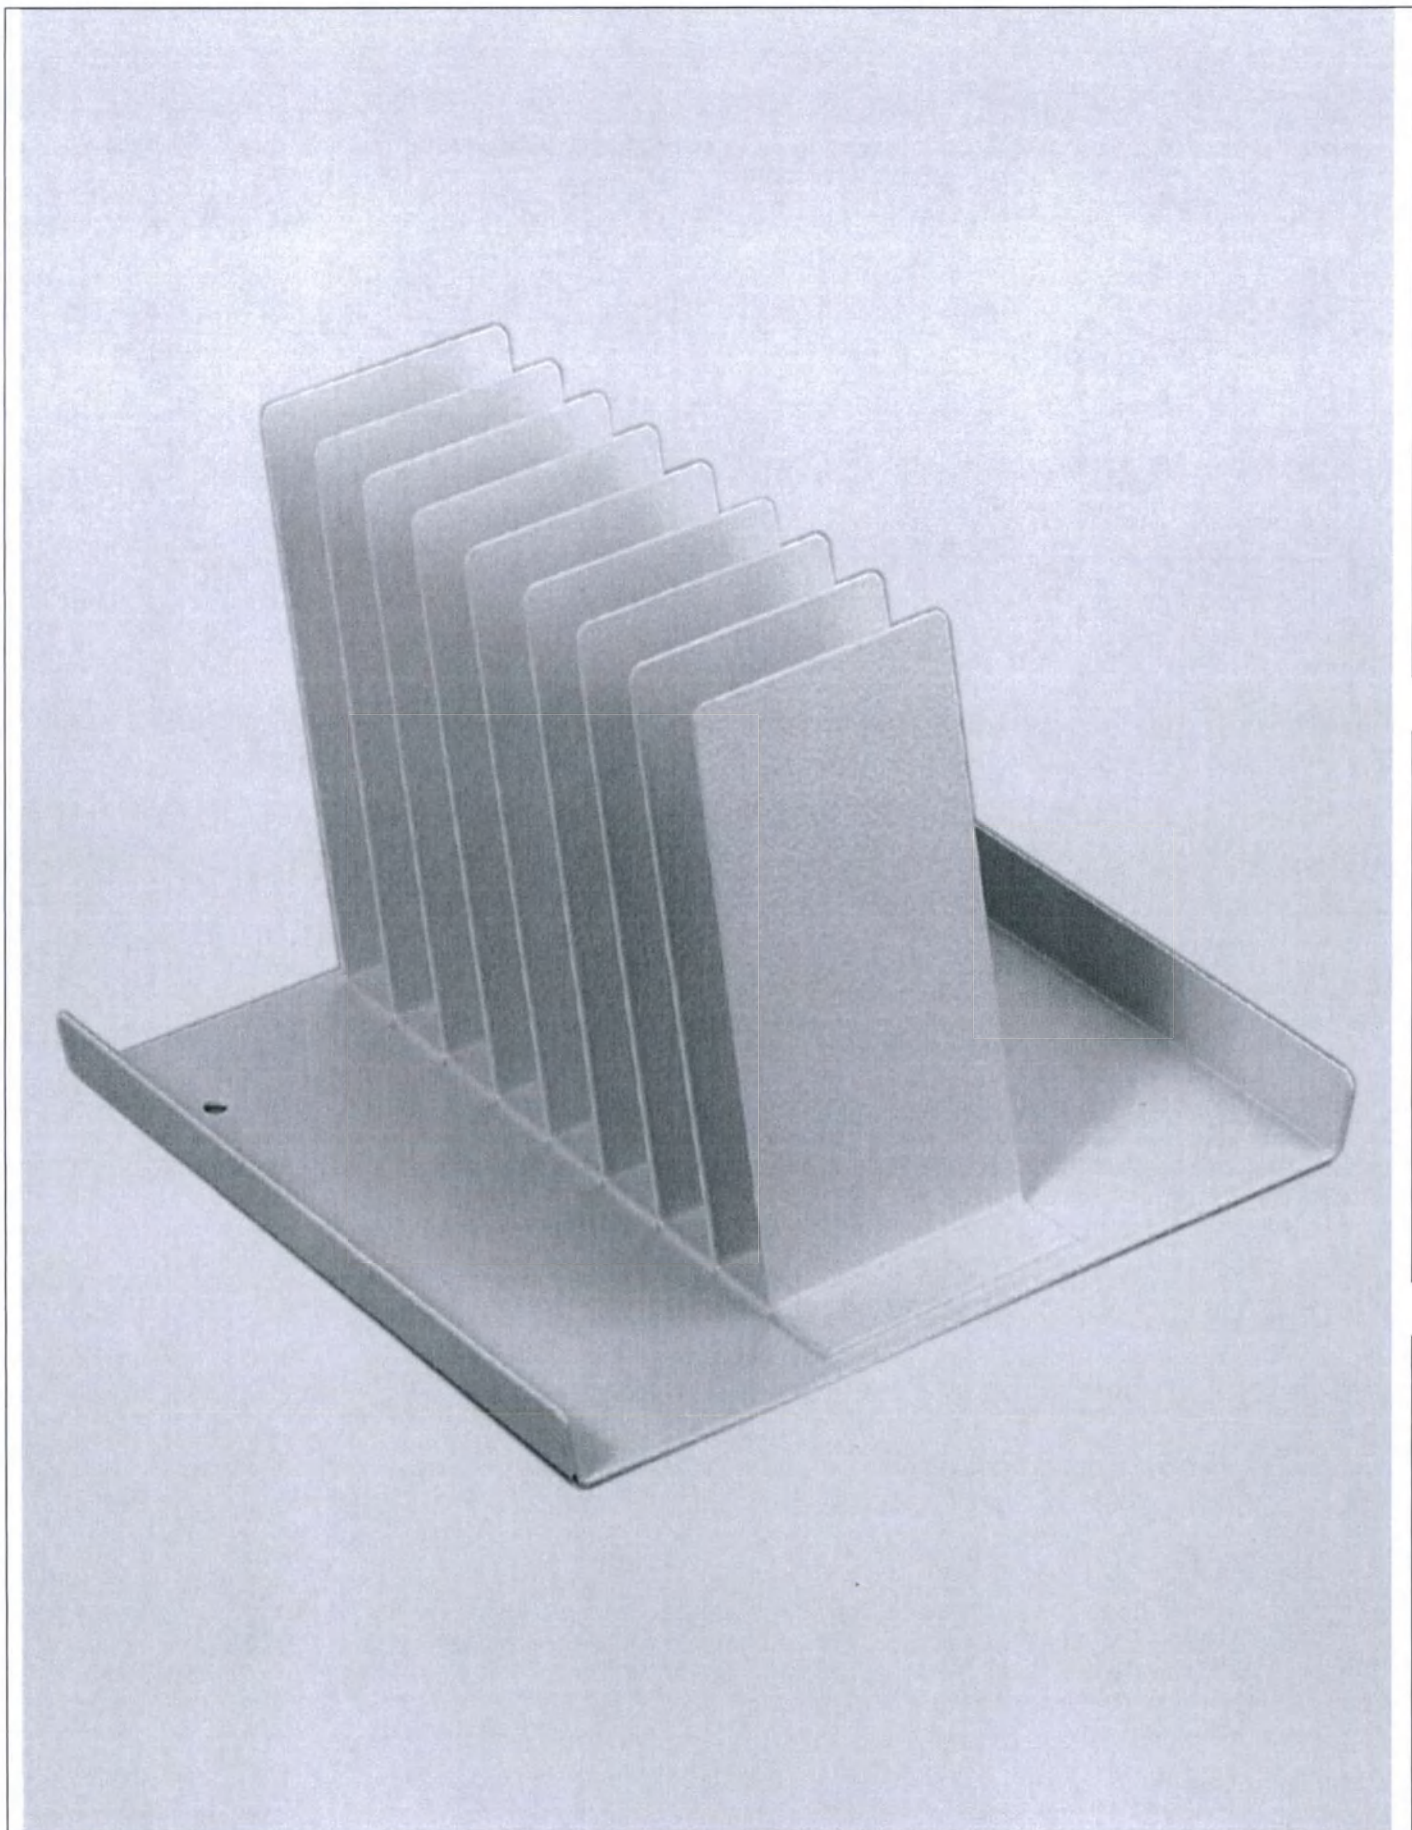


84. Держатель фильтров.

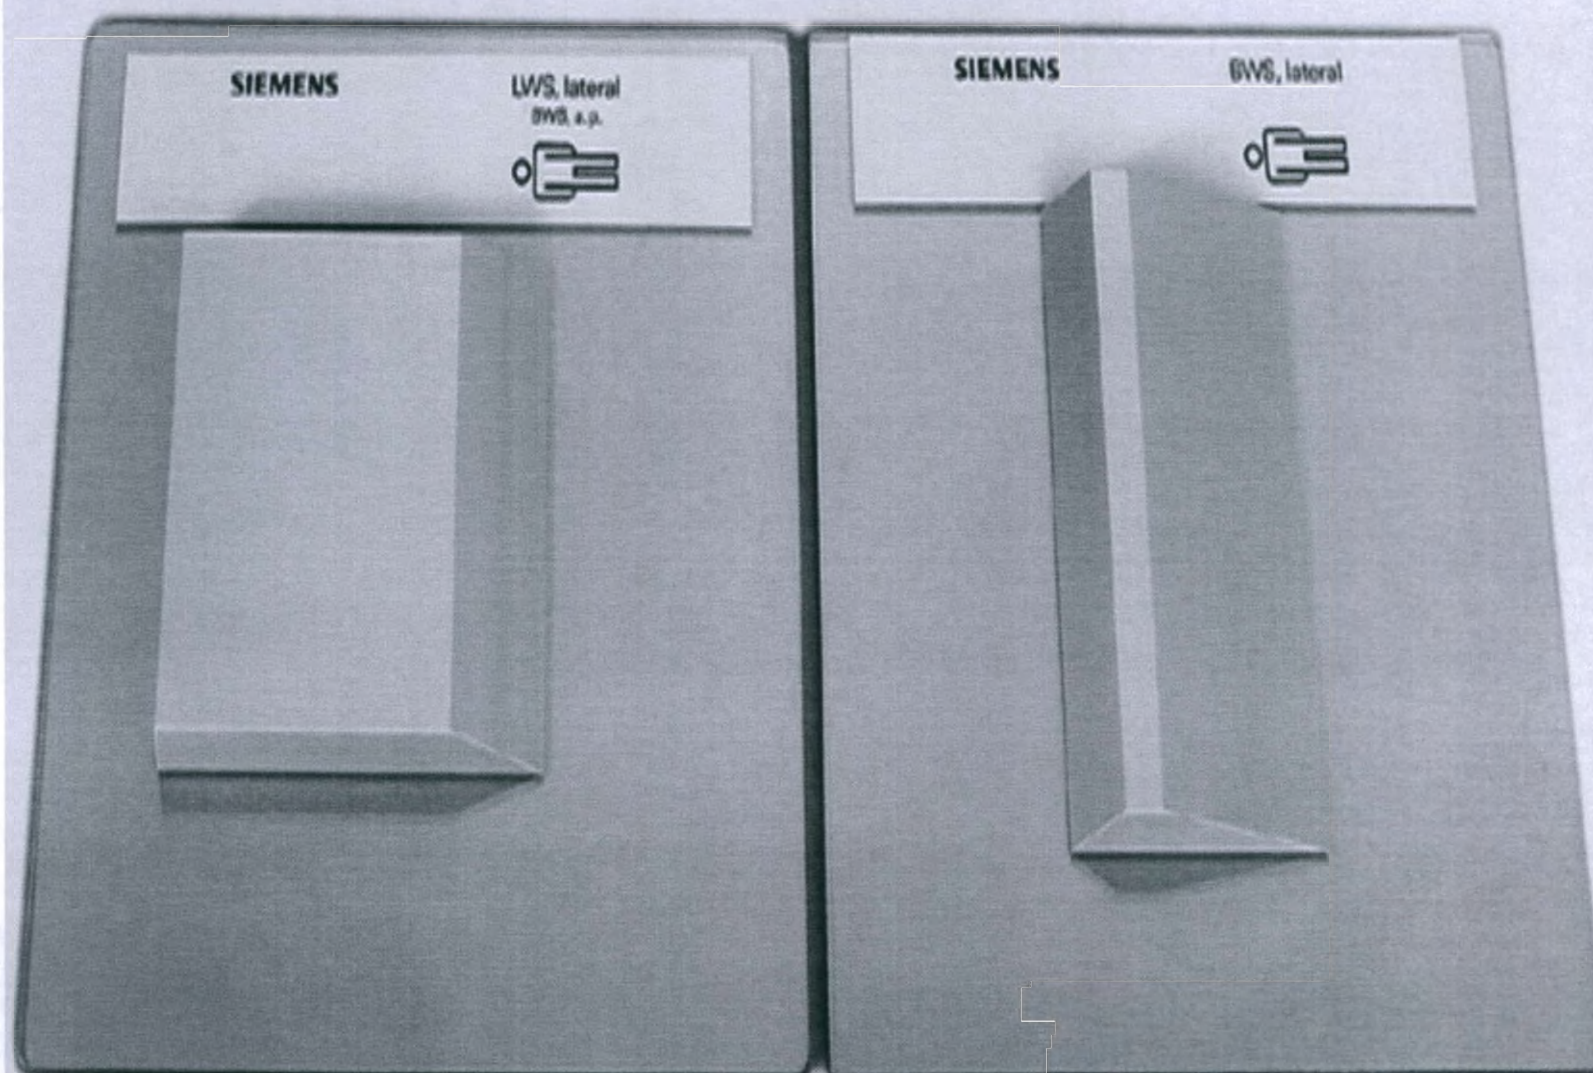


85. Компенсационный фильтр, Т-позвоночник, L-позвоночник.

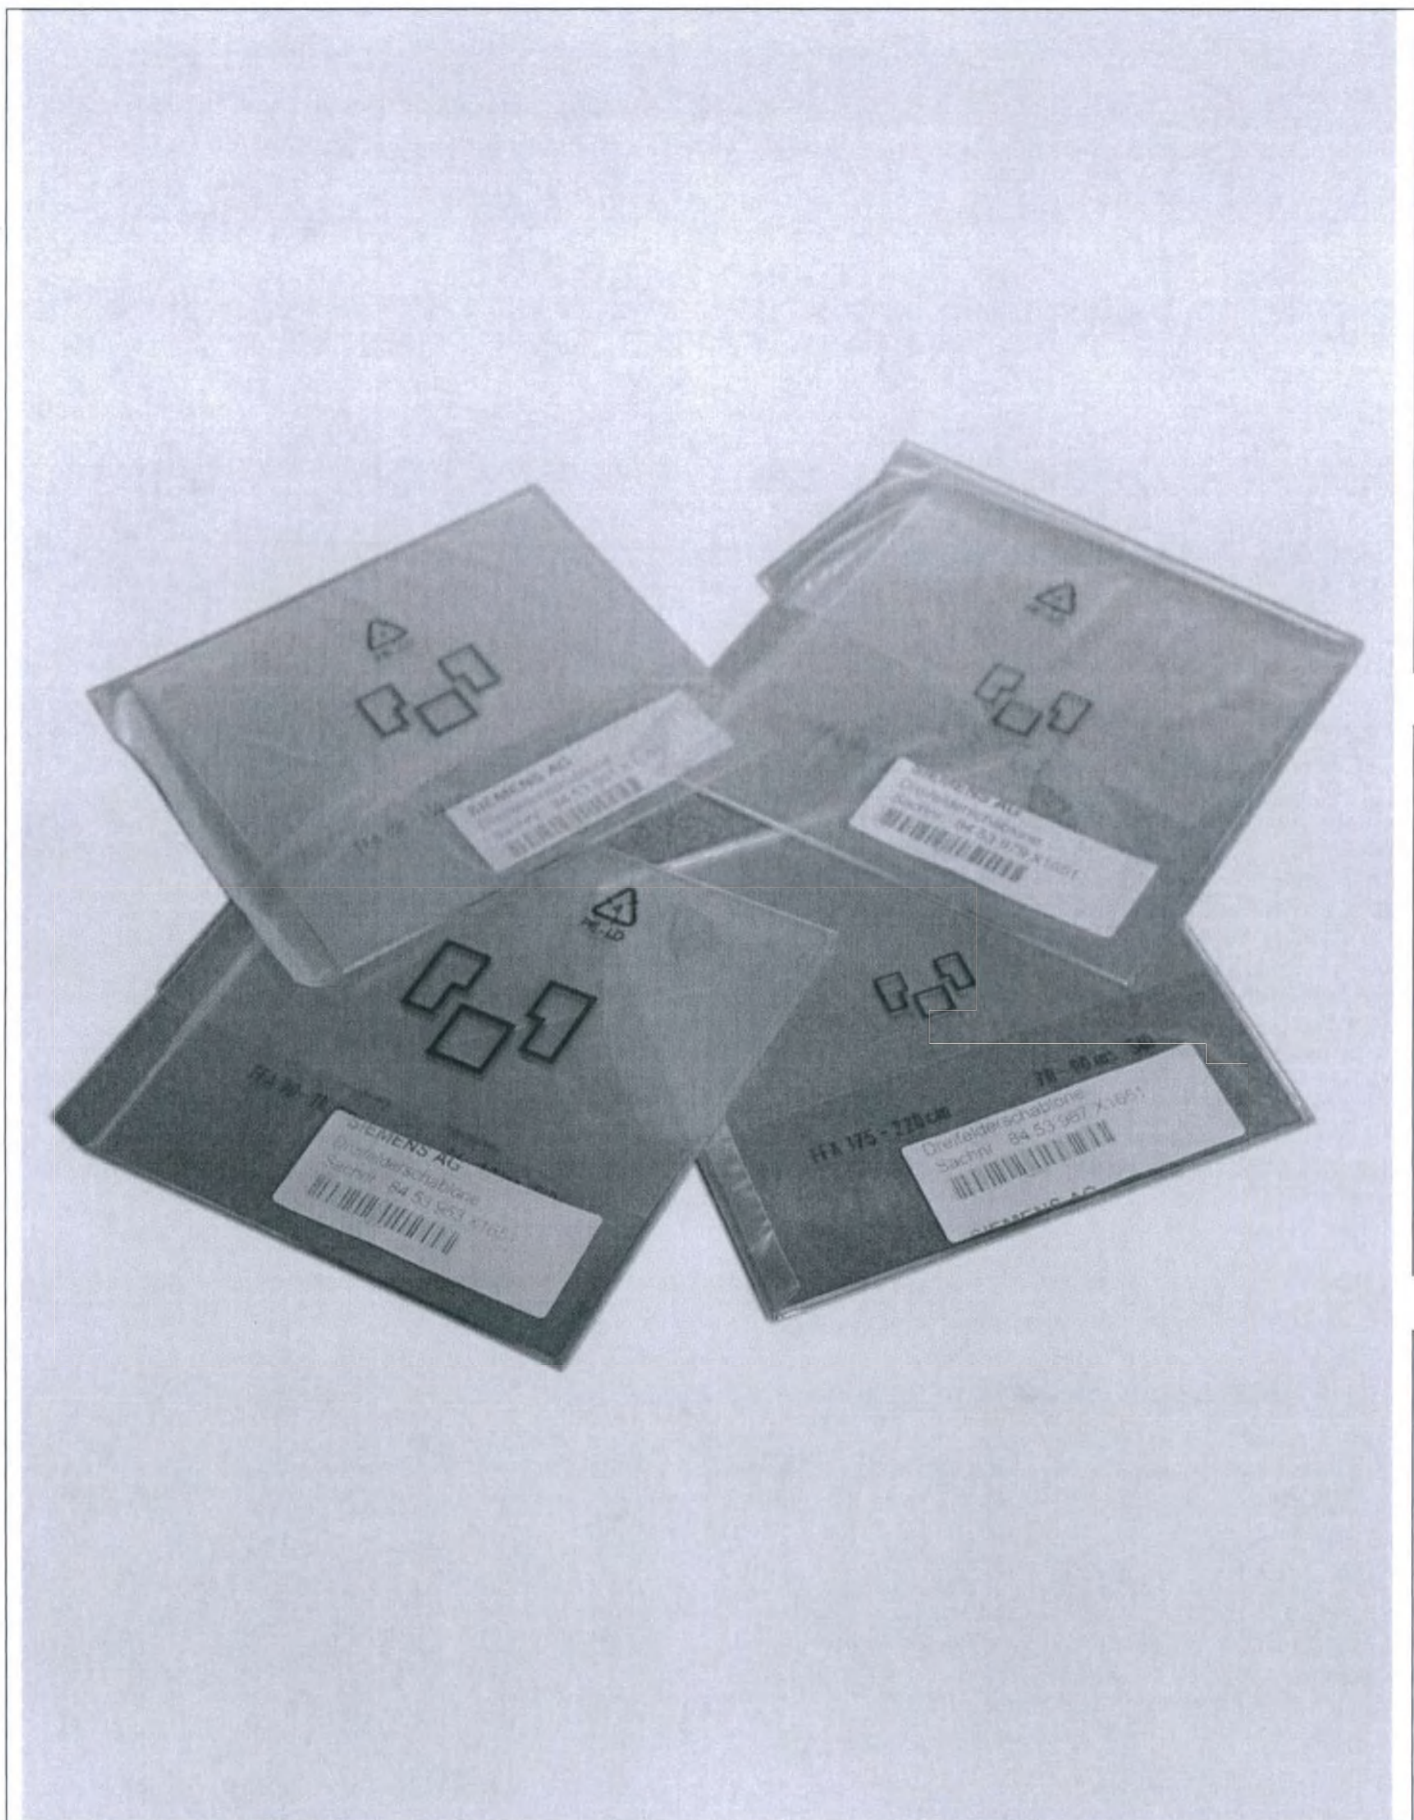


86. Трехпольные шаблоны.

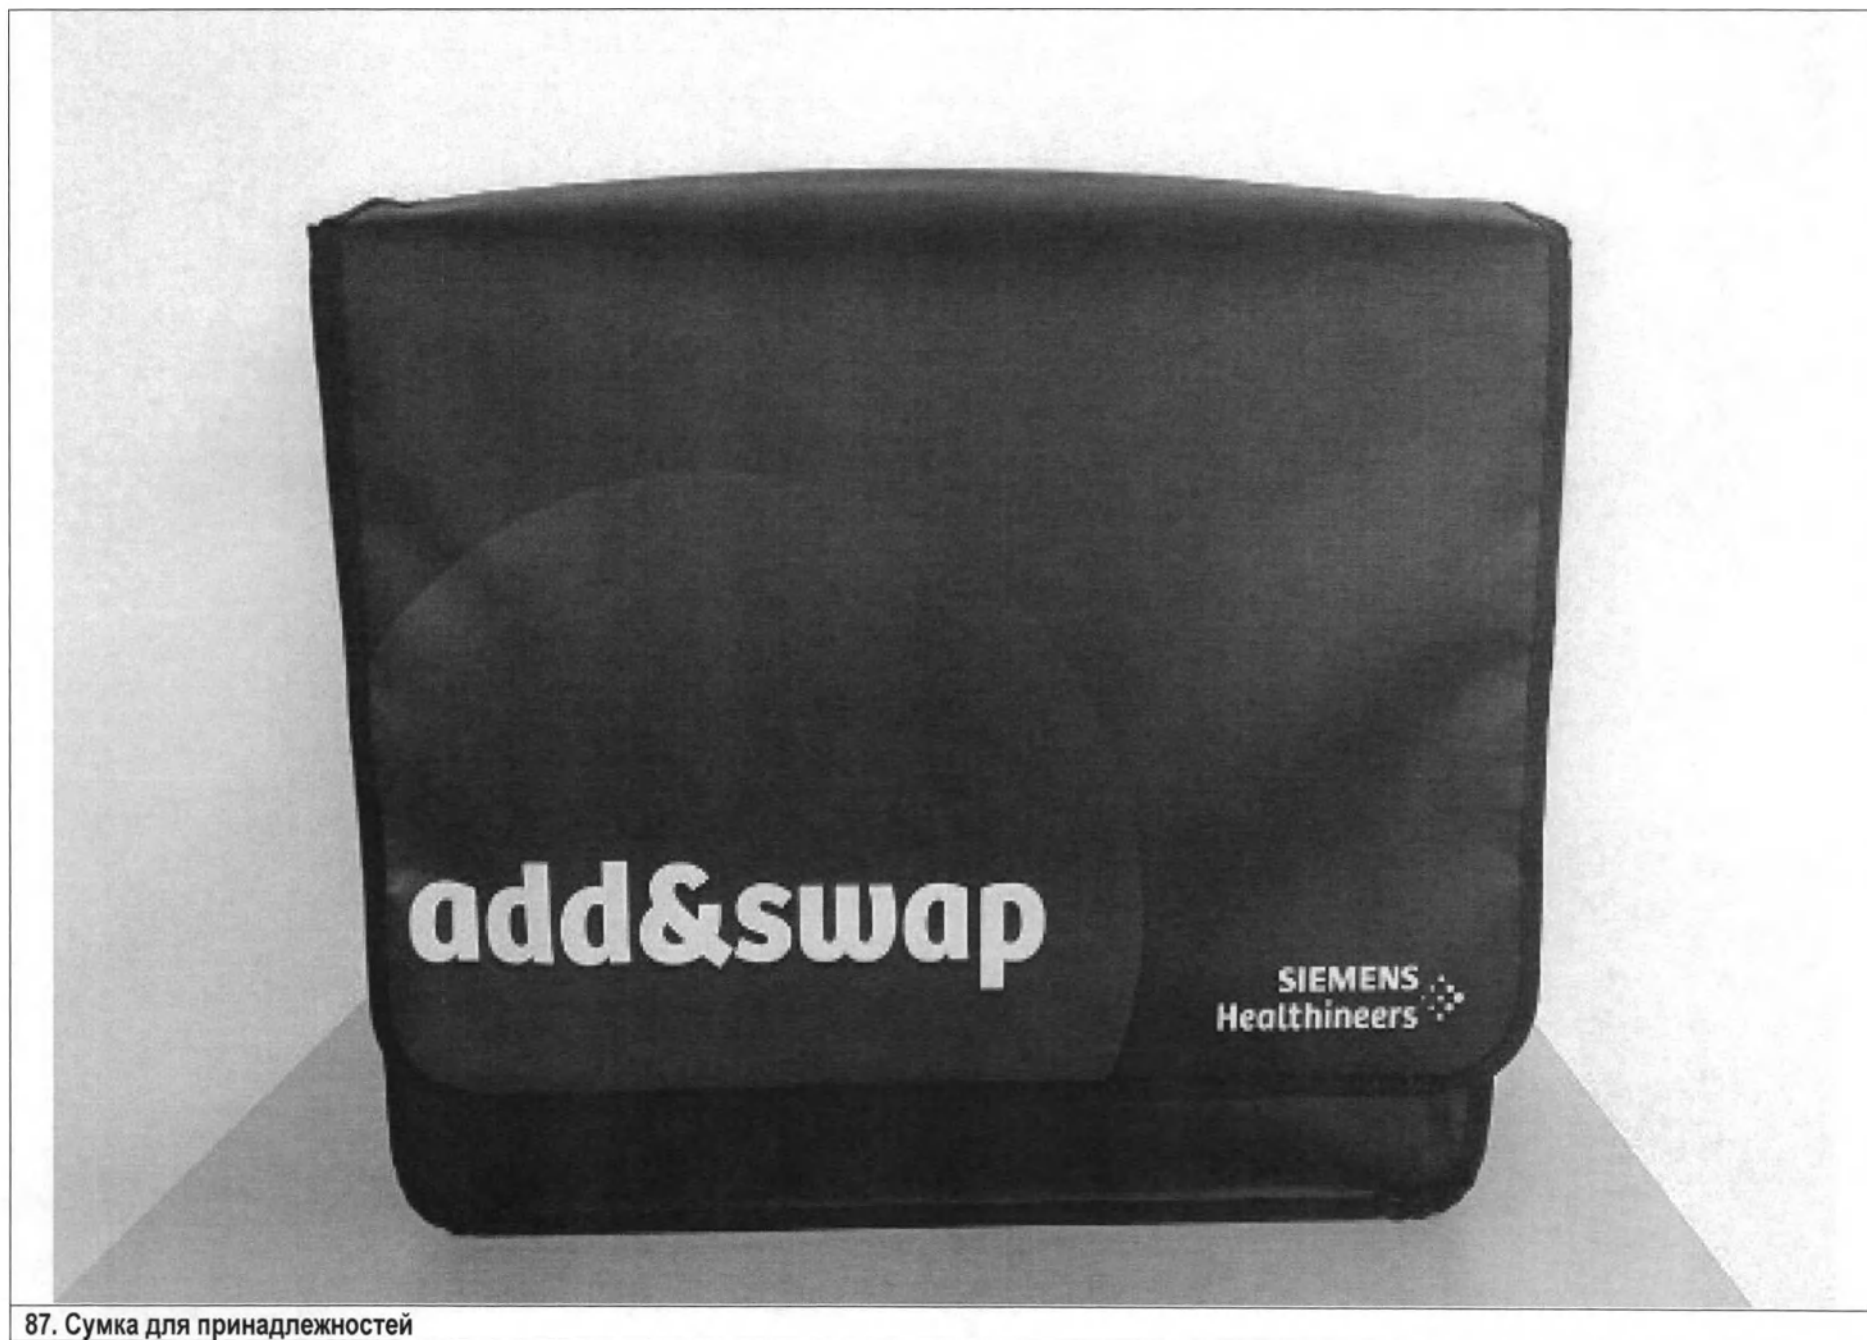


87. Сумка для принадлежностей

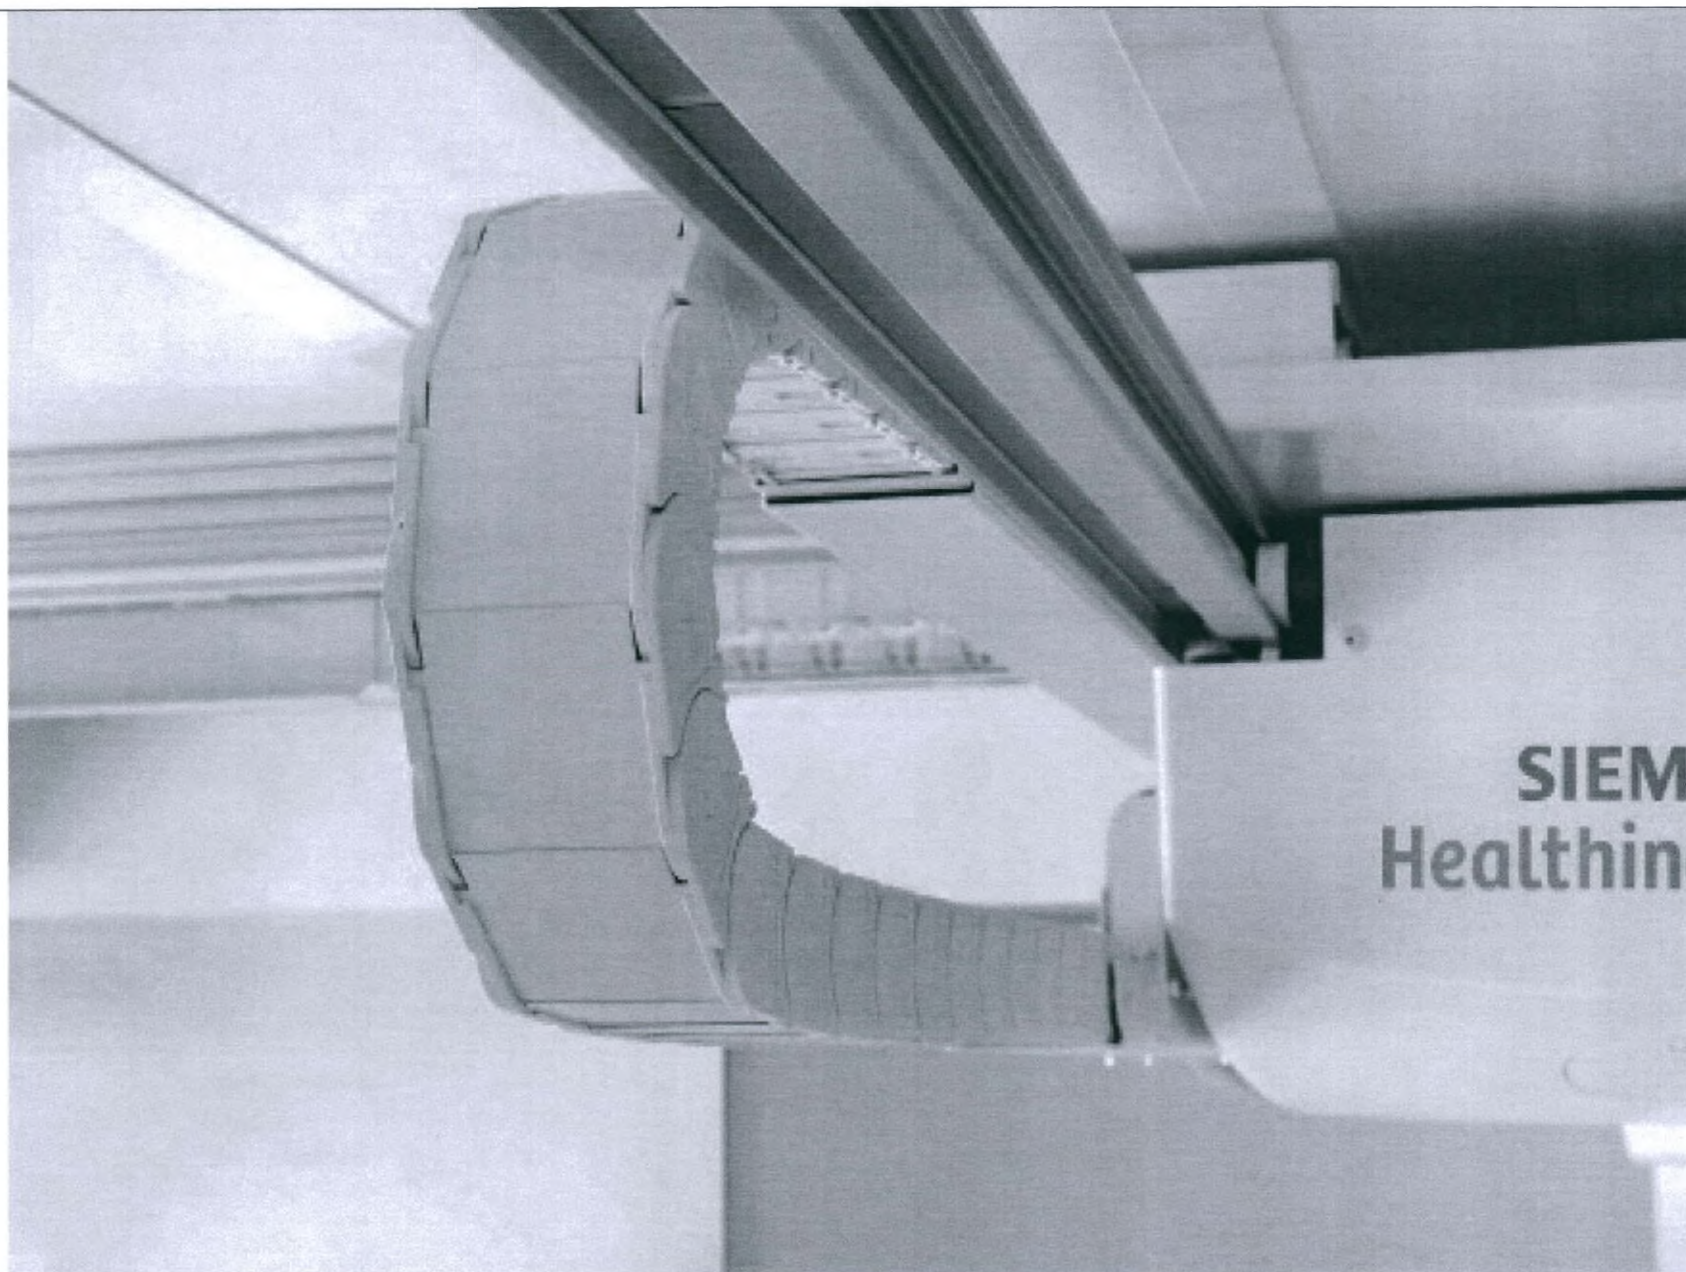

88. Удлинение потолочных рельсов.

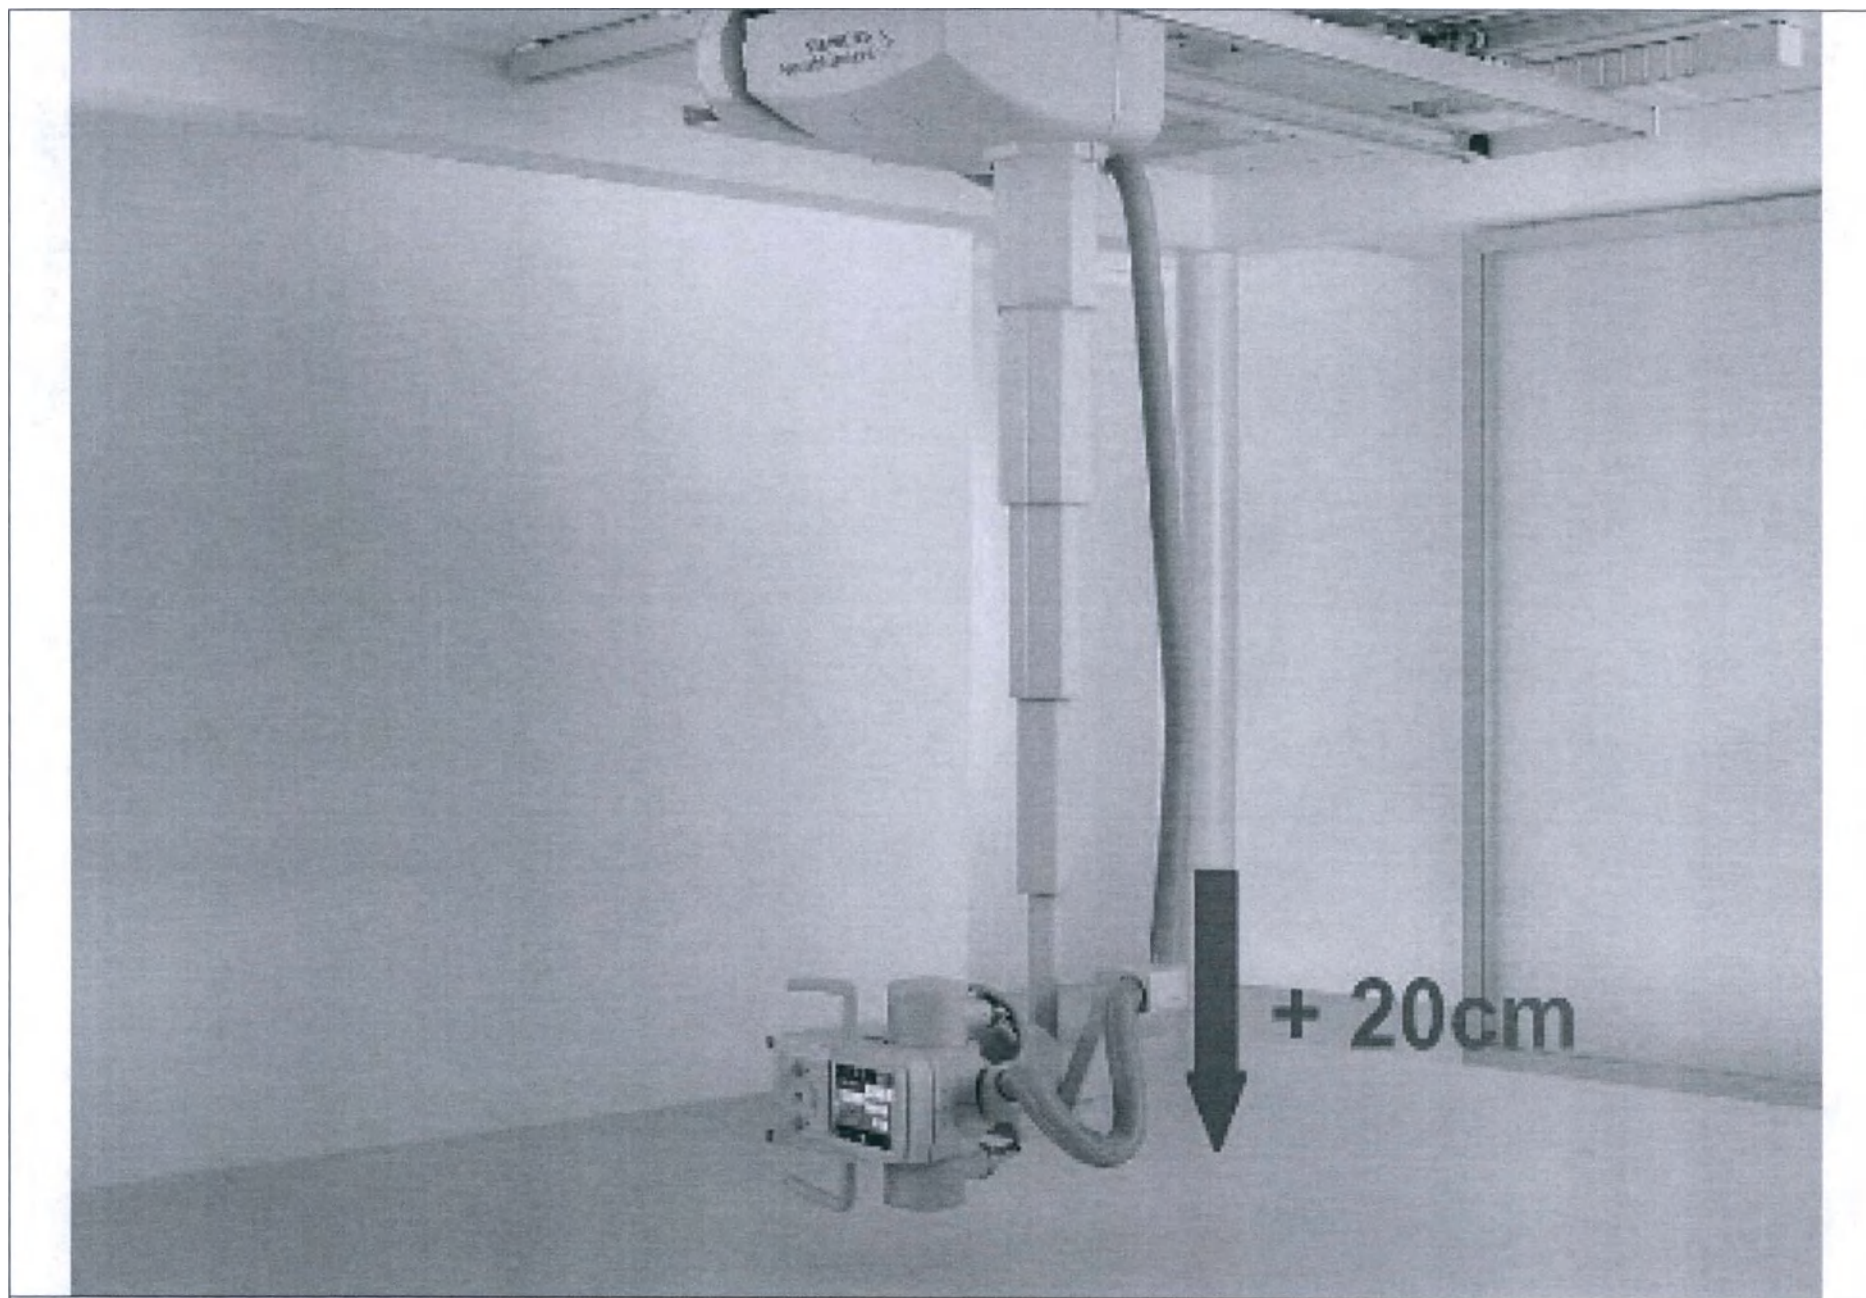

89. Удлинение штатива телескопическое.

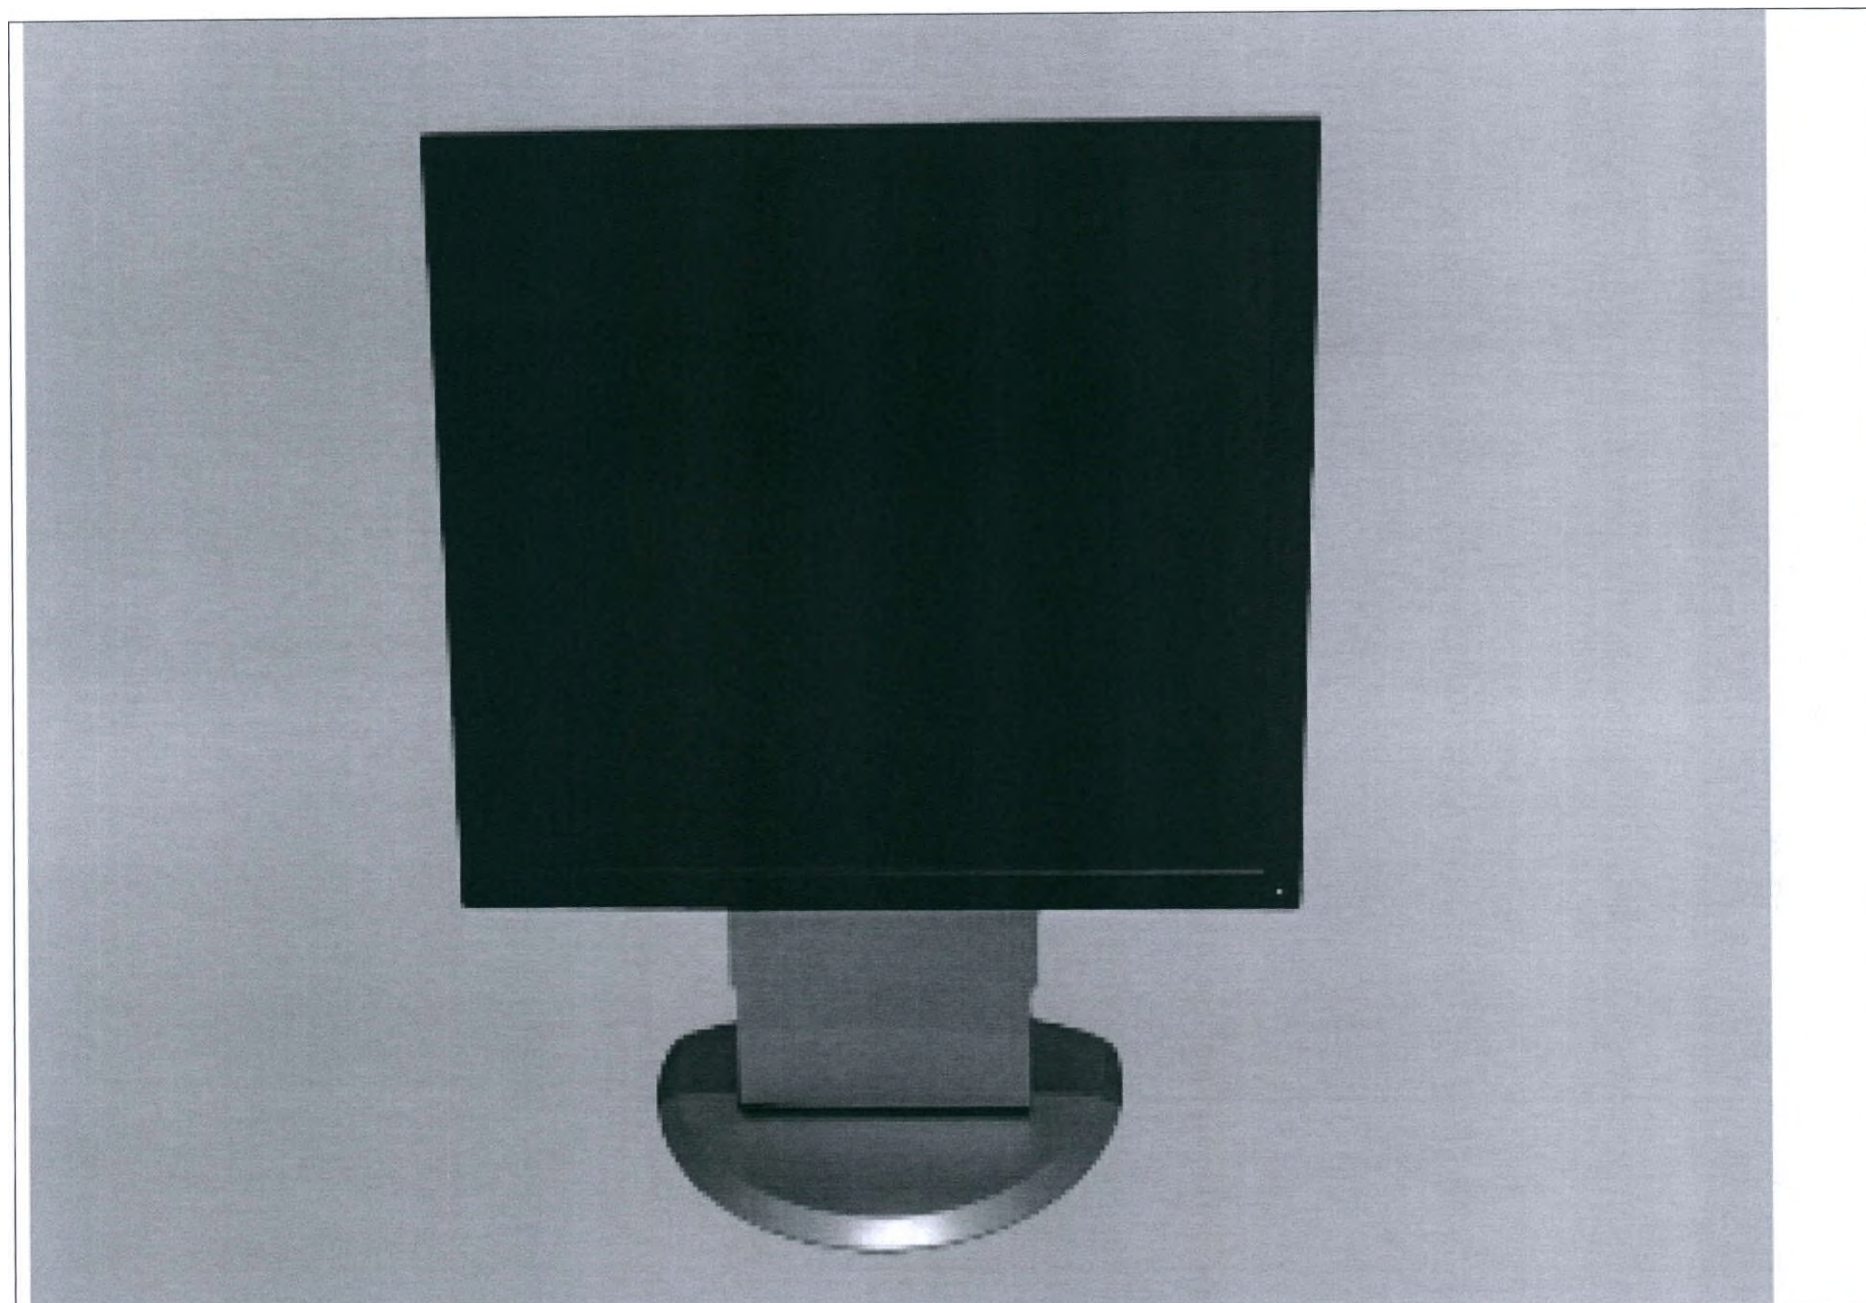


90. Мониторы в комнату для обследований



91. Стол для панели управления



92. Источник бесперебойного питания (для системы визуализации)

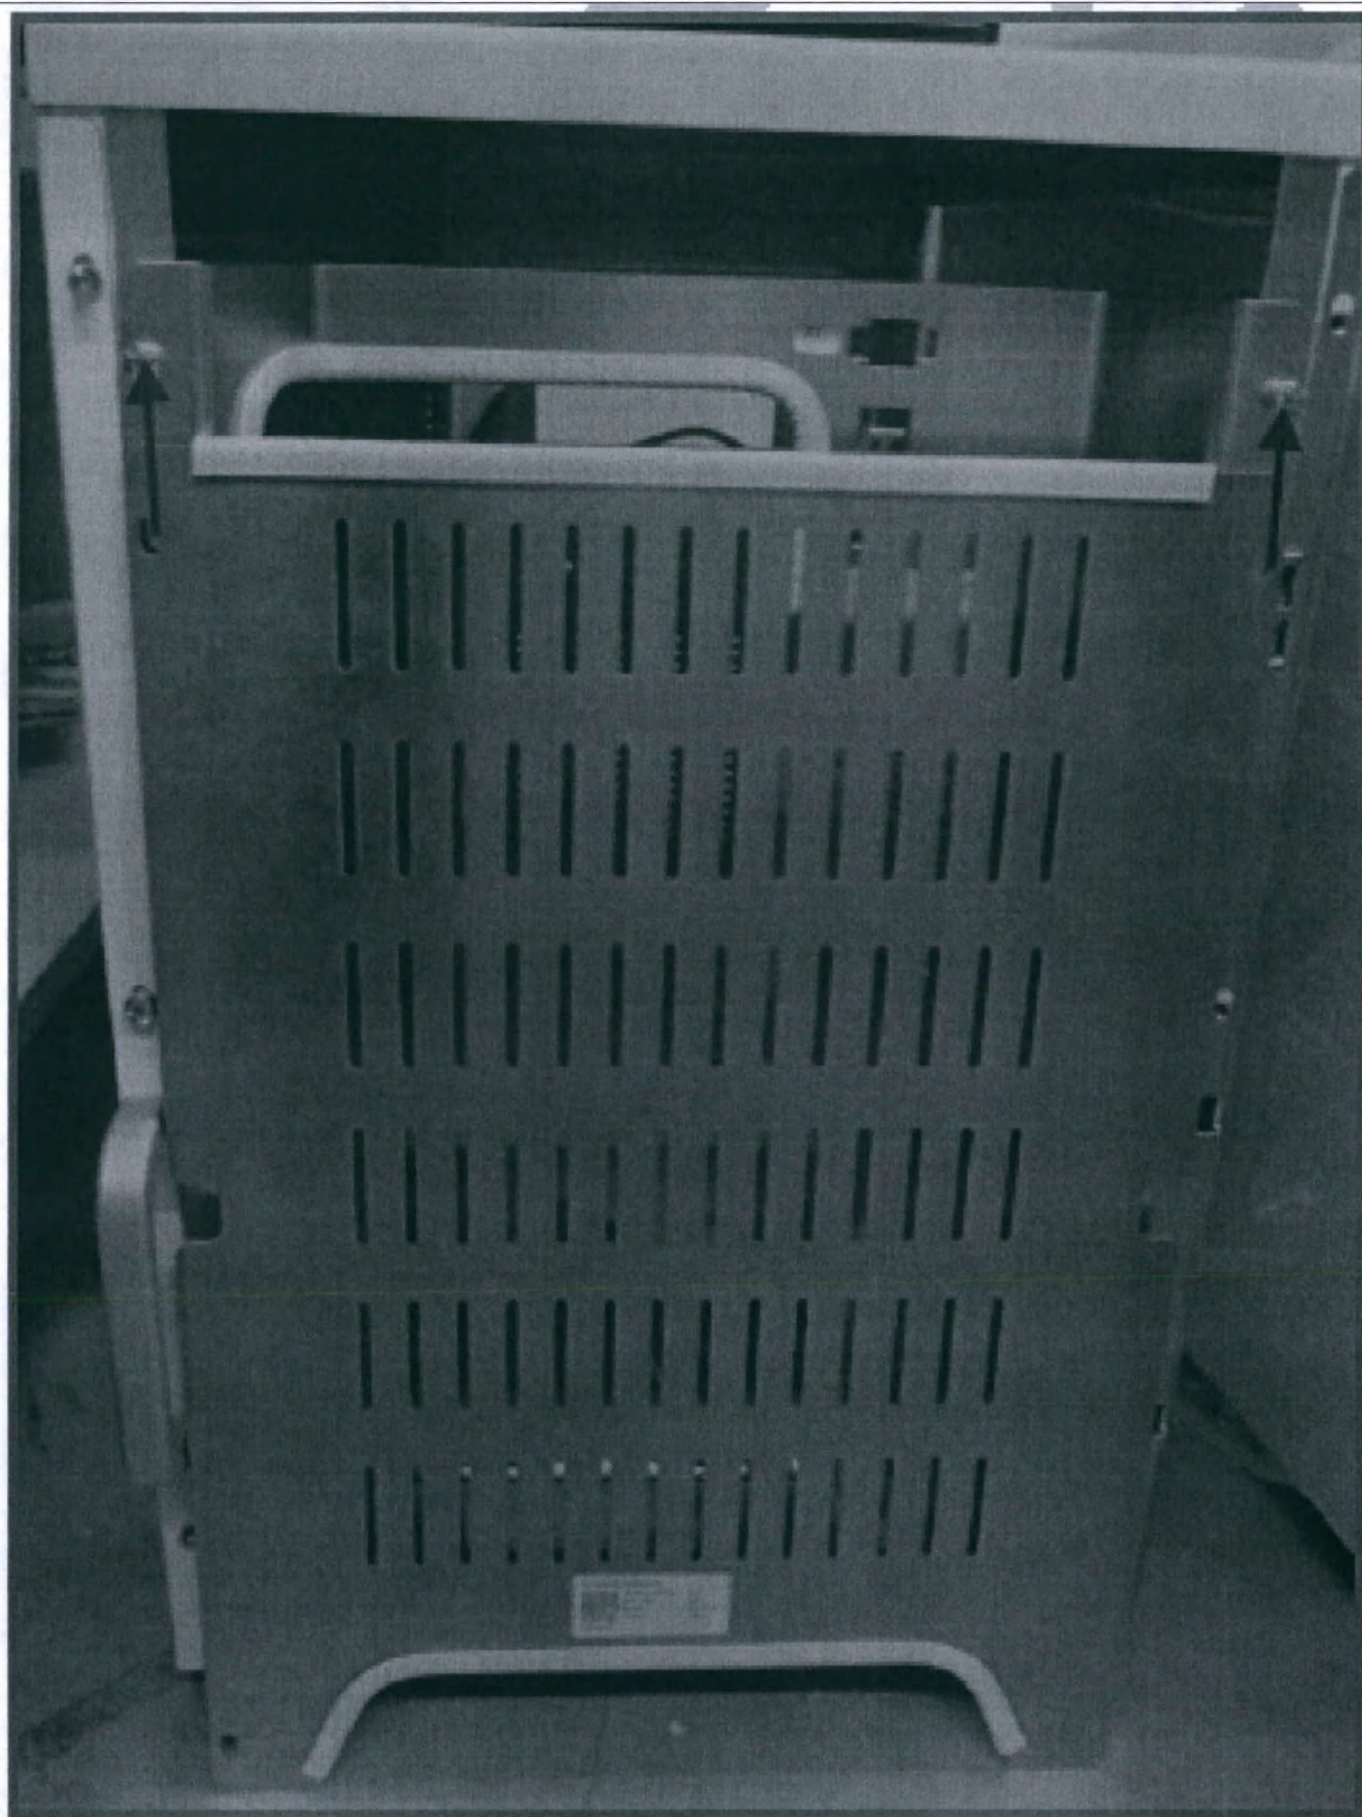

93. Шкаф для хранения кабелей.

Система рентгенодиагностическая Luminos dRF Max в исполнениях с принадлежностями

Вариант исполнения:

Регистрационное удостоверение: РЗН 2017/5656 от dd.мм.гггг

Страна производства: Германия

Дата производства и серийный номер указаны на основной маркировке изделия

Назначение; нормативная документация, требованиям которой соответствует медицинское изделие; массогабаритные характеристики и срок службы изделия указаны в документации пользователя

Уполномоченный представитель производителя:

ООО «Сименс Здравоохранение», 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д.96

~3/N/PE 380/400/440/480 В

50/60 Гц

126 кВА / 0,7 кВА



Всего прошито и пронумеровано
88 листа (ов).

ООО «Сименс Здоровохранение»

