



ООО «Терумо Рус»

Бизнес-Центр «Северная Башня»
ул.Тестовская, д.10, 2-ой под., 13-й этаж,
Помещение I, офис 5
123112, Москва, Россия,
Tel.: +7 495 988 4740

www.terumo-europe.com

Фотографические изображения медицинского изделия
***Интродьюсер RADIFOCUS® INTRODUCER II в различных
вариантах исполнения***

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель финансово-административного
отдела, Главный бухгалтер ООО «Терумо Рус»

(по Доверенности от 11.03.2022 г.)

«20»

июня

Капустина С.В.

2022 г.




RADIFOCUS® STERILE EO

TERUMO
RADIFOCUS® INTRODUCER II
Introducer

Fr. 4

REF: RS*B40K10MQ

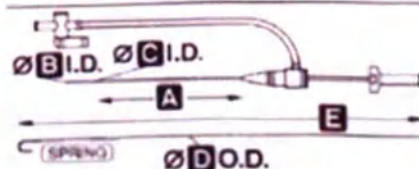

A 10cm	D 0.035" (MAX 0.08mm)
B 0.035" (MIN 0.90mm)	E 45cm
C 1.45mm (MIN 1.33mm)	

LOT: 140228 **EXP: 2016-07**

TERUMO CORPORATION
44-1, 2-CHOME, HATAGAYA, SHIBUYA-KU, TOKYO 151-8502, JAPAN — MADE IN JAPAN
TERUMO EUROPE N.V. — INTERLEUVENLAAN 40, 3001 LEUVEN, BELGIUM
Aashima Factory of Terumo Corporation 180, Namagata, Fushimi-City, Shiga-Ken, Fushimi, 514-0015, Japan


CE 0197

RADIFOCUS® STERILE EO

TERUMO
RADIFOCUS® INTRODUCER II
Introducer

Fr. 5

REF: RS+B50N10AQ

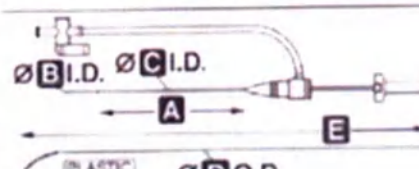

A 10cm	D 0.038" (MAX 0.99mm)
B 0.038" (MIN 1.00mm)	E 45cm
C 1.78mm (MIN 1.65mm)	

LOT: 131212 **EXP: 2016-05**

TERUMO CORPORATION
44-1, 2-CHOME, HATAGAYA, SHIBUYA-KU, TOKYO 151-8502, JAPAN — MADE IN VIETNAM
TERUMO EUROPE N.V. — INTERLEUVENLAAN 40, 3001 LEUVEN, BELGIUM
TERUMO VIETNAM CO., LTD. LOT 44A-B-C QUANG MINH INDUSTRIAL ZONE, ME LINH DISTRICT, HANOI CITY, VIETNAM

CE 0197

Интродьюсер RADIFOCUS® INTRODUCER II в различных вариантах исполнения (Пример этикетки на пользовательской упаковке (индивидуальной коробке) изделия)

LOT: 140228 EXP: 2016-07

REF: RS*B40K10MQ

TERUMO **RADIFOCUS® INTRODUCER II** Fr. 4

CE 0197 Fr. 4

TERUMO CORPORATION
4th FLOOR, HATAGAYA, SHIBUYA-KU, TOKYO 151-8501, JAPAN
TERUMO EUROPE N.V. - INTERLEUVENLAAN 40 3001 LEUVEN, BELGIUM

LOT: 140228 EXP: 2016-07

140228 2016-07

TERUMO CORPORATION
4th FLOOR, HATAGAYA, SHIBUYA-KU, TOKYO 151-8501, JAPAN
TERUMO EUROPE N.V. - INTERLEUVENLAAN 40 3001 LEUVEN, BELGIUM

LOT: 131212 EXP: 2016-05

REF: RS+B50N10AQ

TERUMO **RADIFOCUS® INTRODUCER II** Fr. 5

CE 0197 Fr. 5

TERUMO CORPORATION
4th FLOOR, HATAGAYA, SHIBUYA-KU, TOKYO 151-8501, JAPAN
TERUMO EUROPE N.V. - INTERLEUVENLAAN 40 3001 LEUVEN, BELGIUM

LOT: 131212 EXP: 2016-05


131212 2016-05

TERUMO CORPORATION
4th FLOOR, HATAGAYA, SHIBUYA-KU, TOKYO 151-8501, JAPAN
TERUMO EUROPE N.V. - INTERLEUVENLAAN 40 3001 LEUVEN, BELGIUM




Интродьюсер RADIFOCUS® INTRODUCER II в различных вариантах исполнения	
Производитель: Терумо Корпорейшн, Япония, Terumo Corporation, 44-1, 2-chome, Hatagaya, Shibuya-Ku, Tokyo 151-0072, Japan Произведено в Японии	
См. REF LOT  на основной маркировке производителя	
 STERILE EO    	
Обратитесь к основной маркировке, упаковке и эксплуатационной документации производителя за нормативными сведениями и полной информацией о безопасном использовании изделия.	
 Апиrogenно Нетоксично	Представитель производителя в РФ: ООО «Терумо Рус», Россия, 123112, город Москва, улица Тестовская, дом 10, эт/пом/ком 13/1/5. Тел. + 7 495 988 47 40 Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/4786 от xx.xx.20xx


Интродьюсер RADIFOCUS® INTRODUCER II в различных вариантах исполнения	
Производитель: Терумо Корпорейшн, Япония, Terumo Corporation, 44-1, 2-chome, Hatagaya, Shibuya-Ku, Tokyo 151-0072, Japan Произведено в Вьетнаме	
См. REF LOT  на основной маркировке производителя	
 STERILE EO    	
Обратитесь к основной маркировке, упаковке и эксплуатационной документации производителя за нормативными сведениями и полной информацией о безопасном использовании изделия.	
 Апиrogenно Нетоксично	Представитель производителя в РФ: ООО «Терумо Рус», Россия, 123112, город Москва, улица Тестовская, дом 10, эт/пом/ком 13/1/5. Тел. + 7 495 988 47 40 Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/4786 от xx.xx.20xx

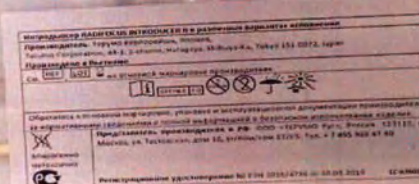


Интродьюсер RADIFOCUS® INTRODUCER II в различных вариантах исполнения (пример пользовательской упаковки (индивидуальной коробки))

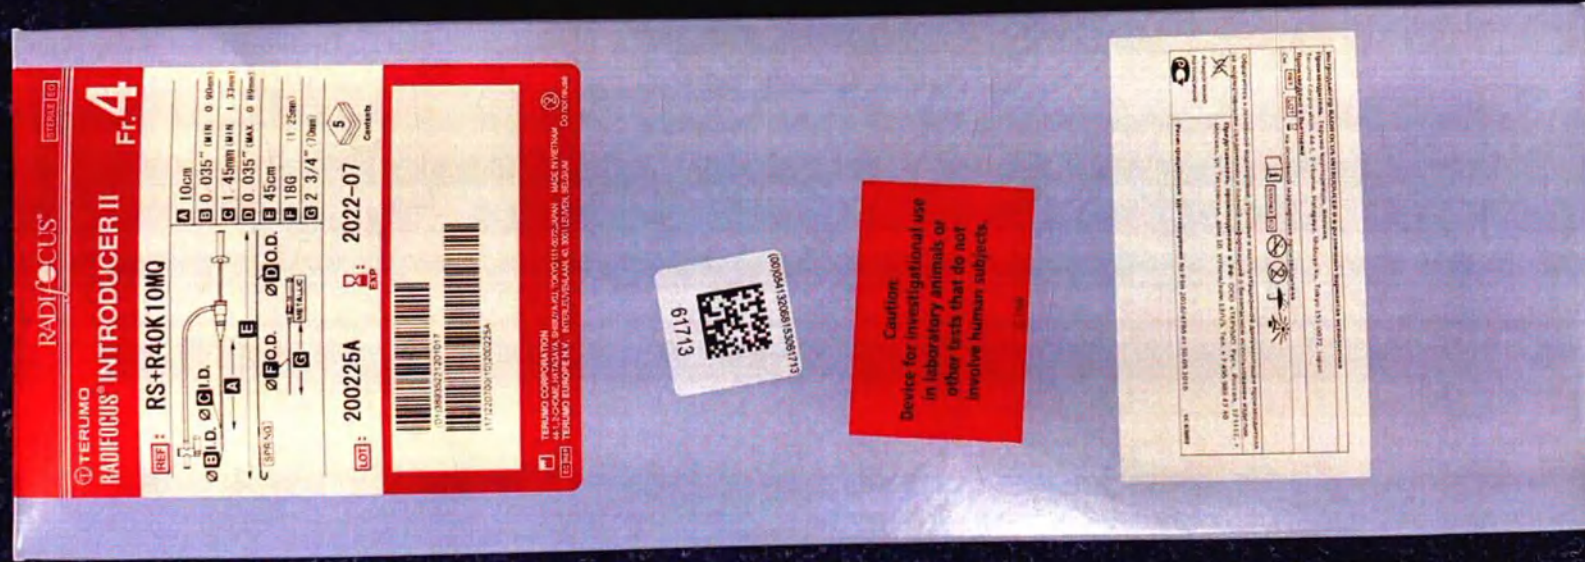


Интродьюсер RADIFOCUS® INTRODUCER II (пример внешнего вида медицинского изделия в комплекте поставки RADIFOCUS®)
3. Мини проводник. 4. Шприц. 5. Пункционная игла с пластиковой канюлей

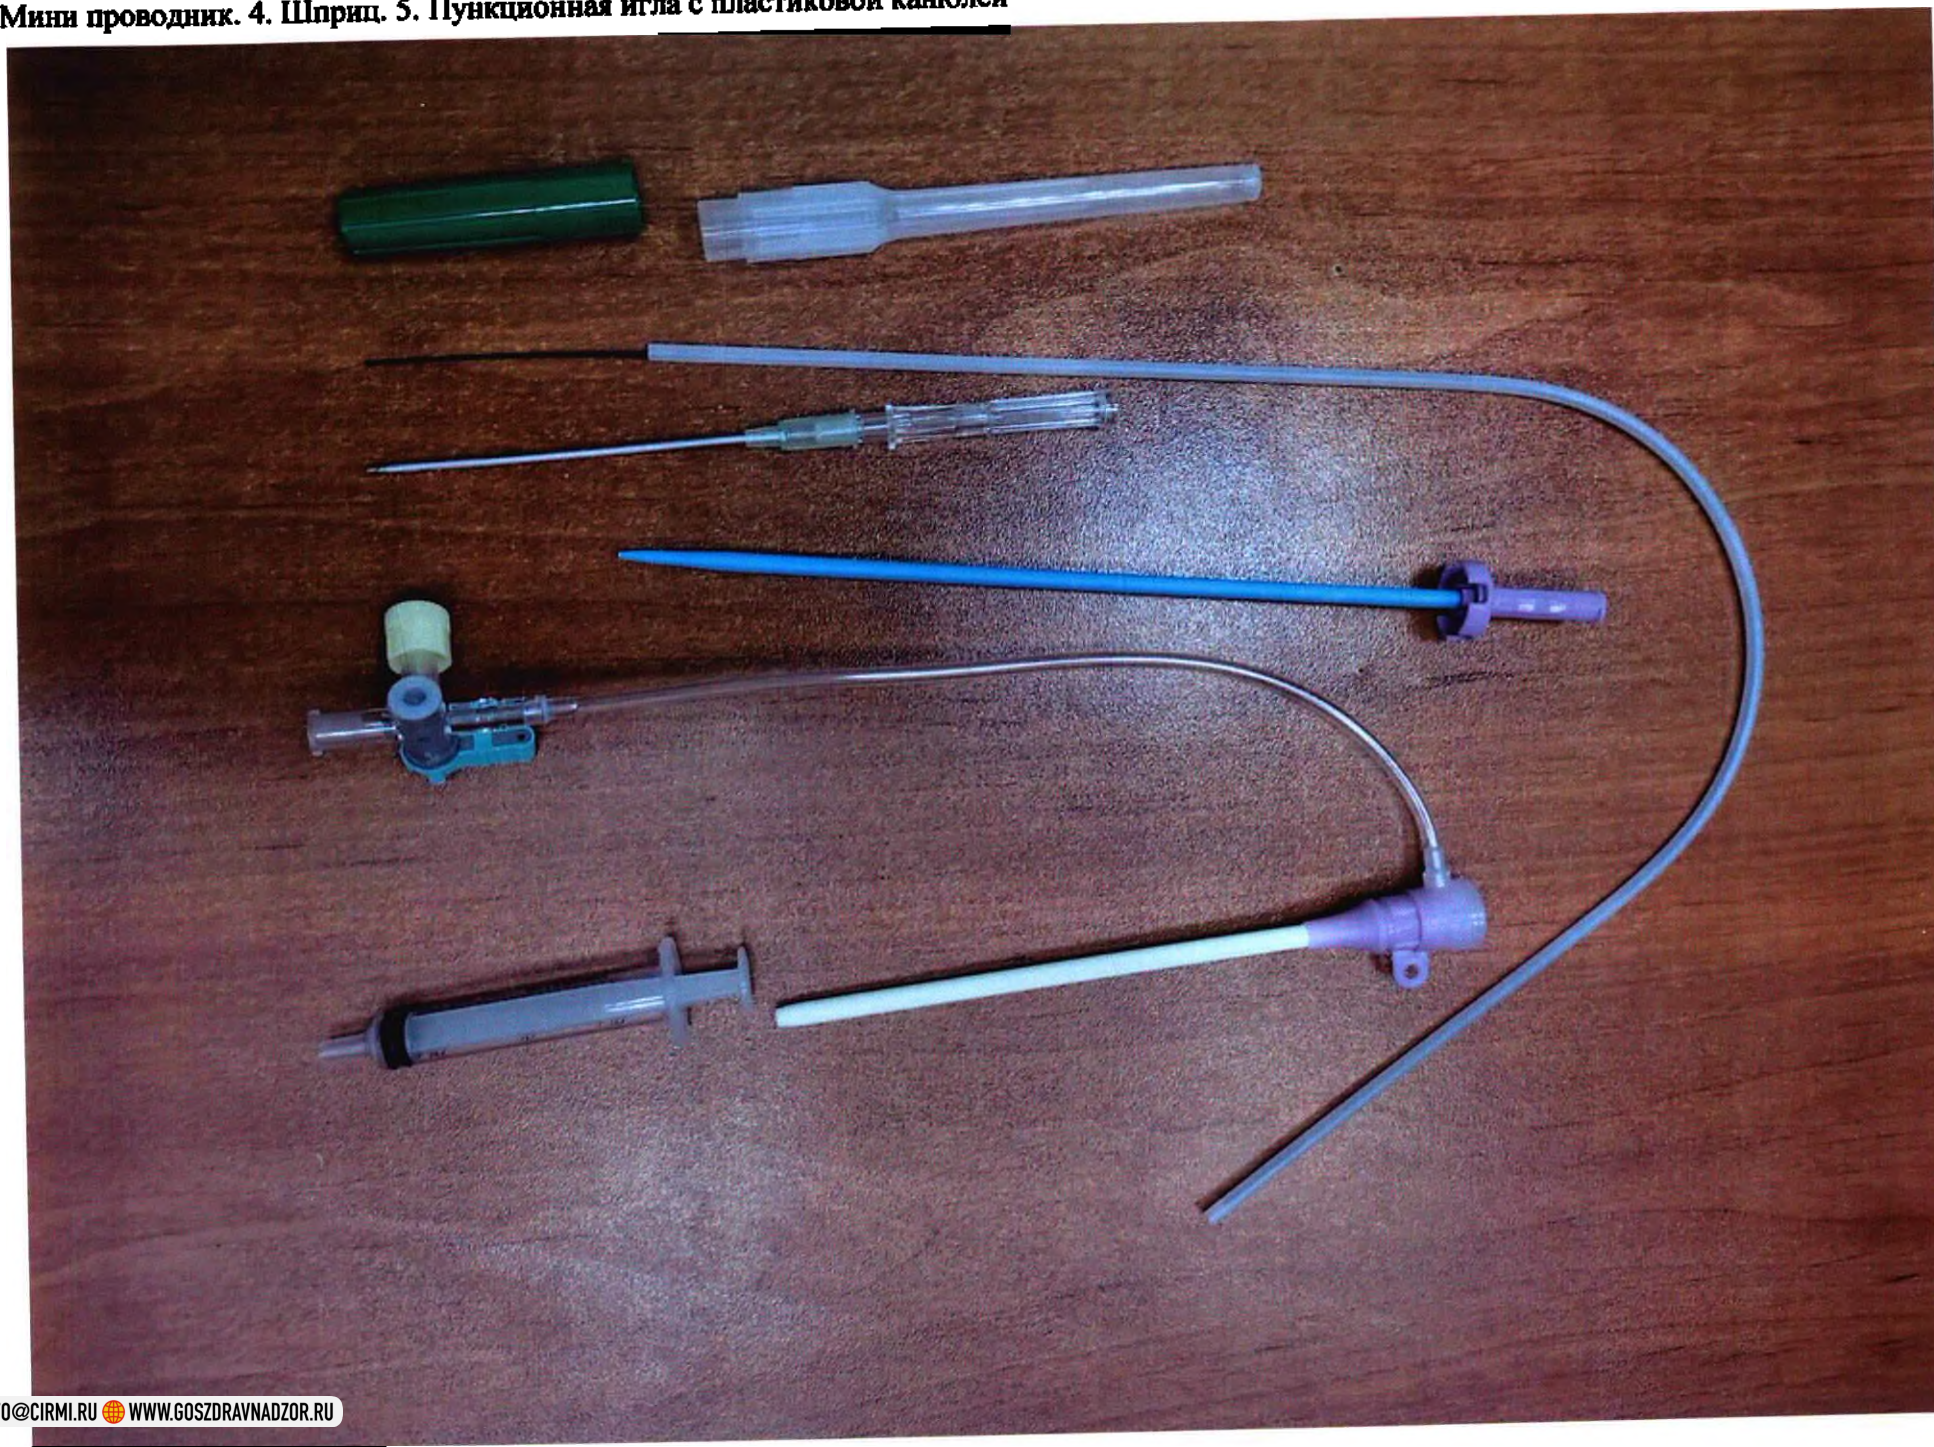


3. Мини проводник. 4. Шприц. 5. Пункционная игла с пластиковой канюлей 6. Устройство для введения проводника.

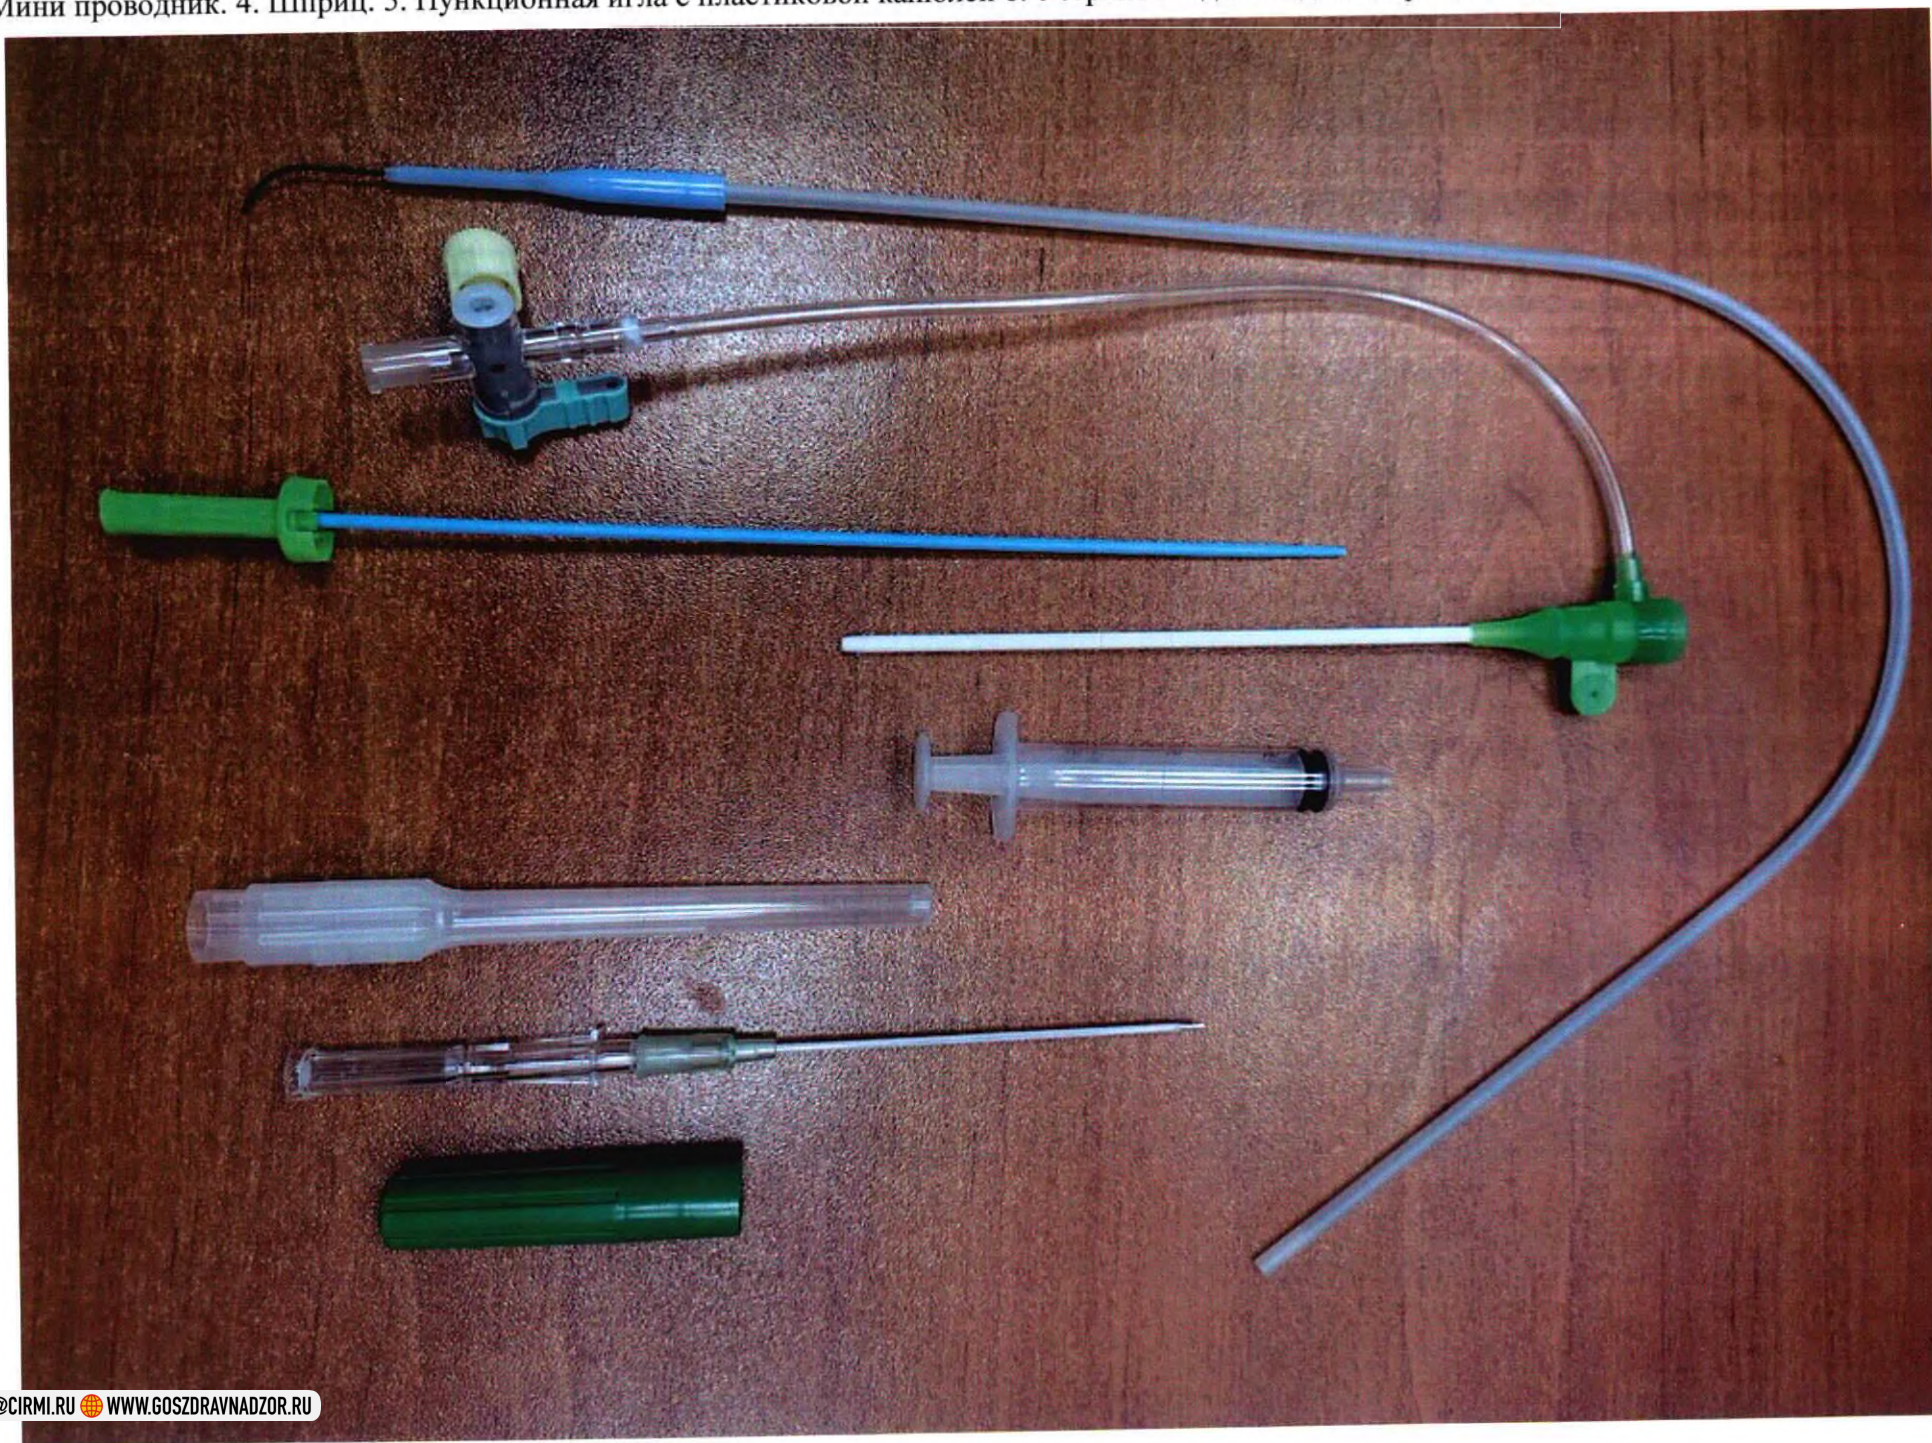


Интродьюсер RADIFOCUS® INTRODUCER II (пример внешнего вида медицинского изделия в комплекте поставки: 1. Интродьюсер; 2. Дилататор.
3. Мини проводник.

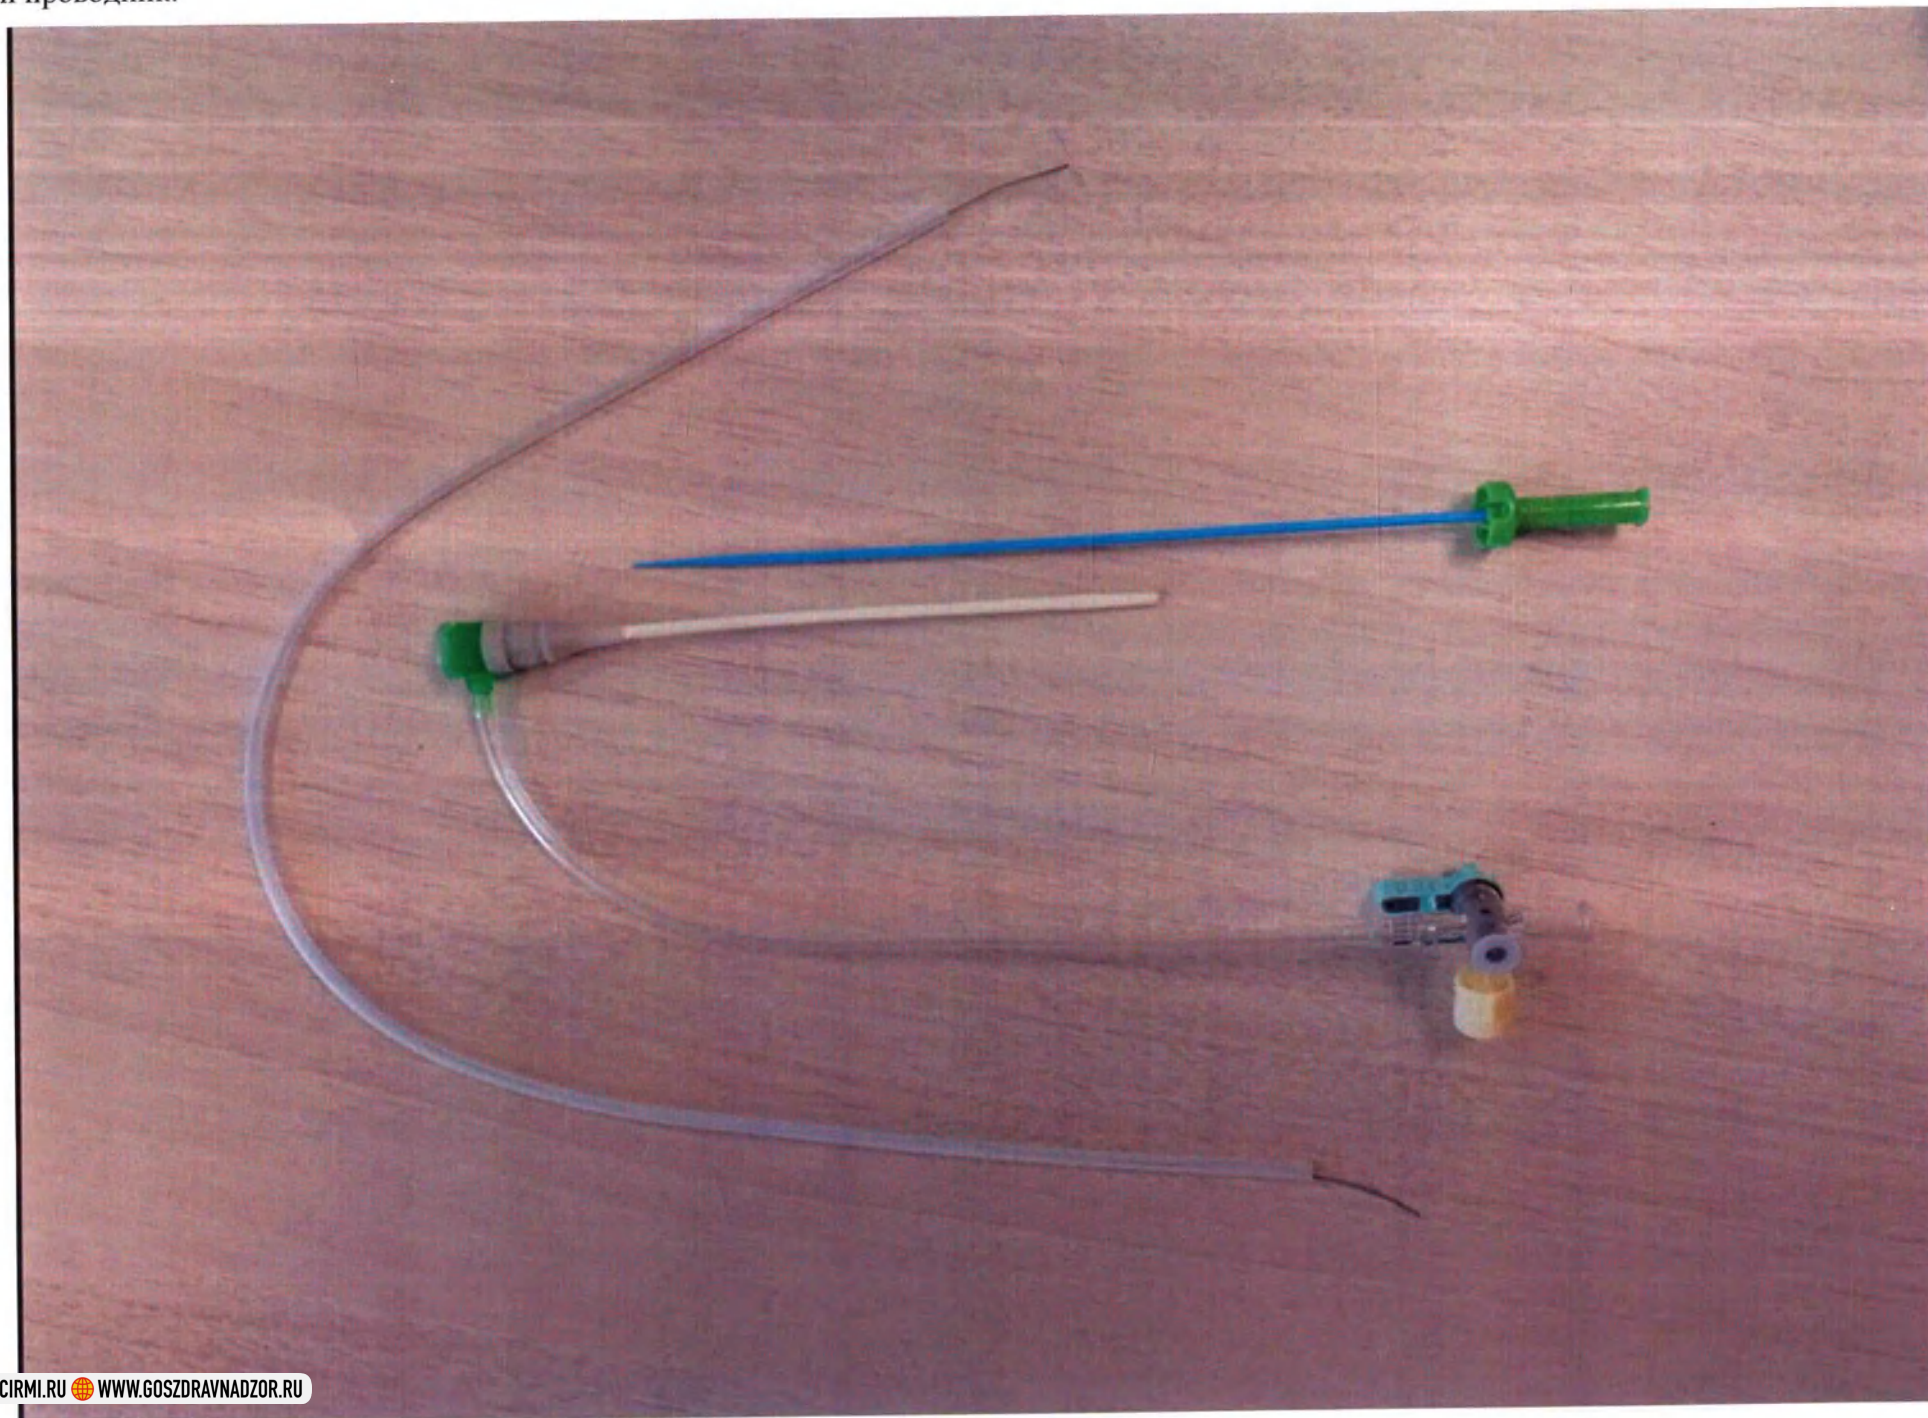


Интродюсер RADIFOCUS® INTRODUCER II (пример внешнего вида медицинского изделия в комплекте поставки: 1.Интродюсер; 2. Дилататор.
3. Мини проводник. 4. Устройство для введения проводника

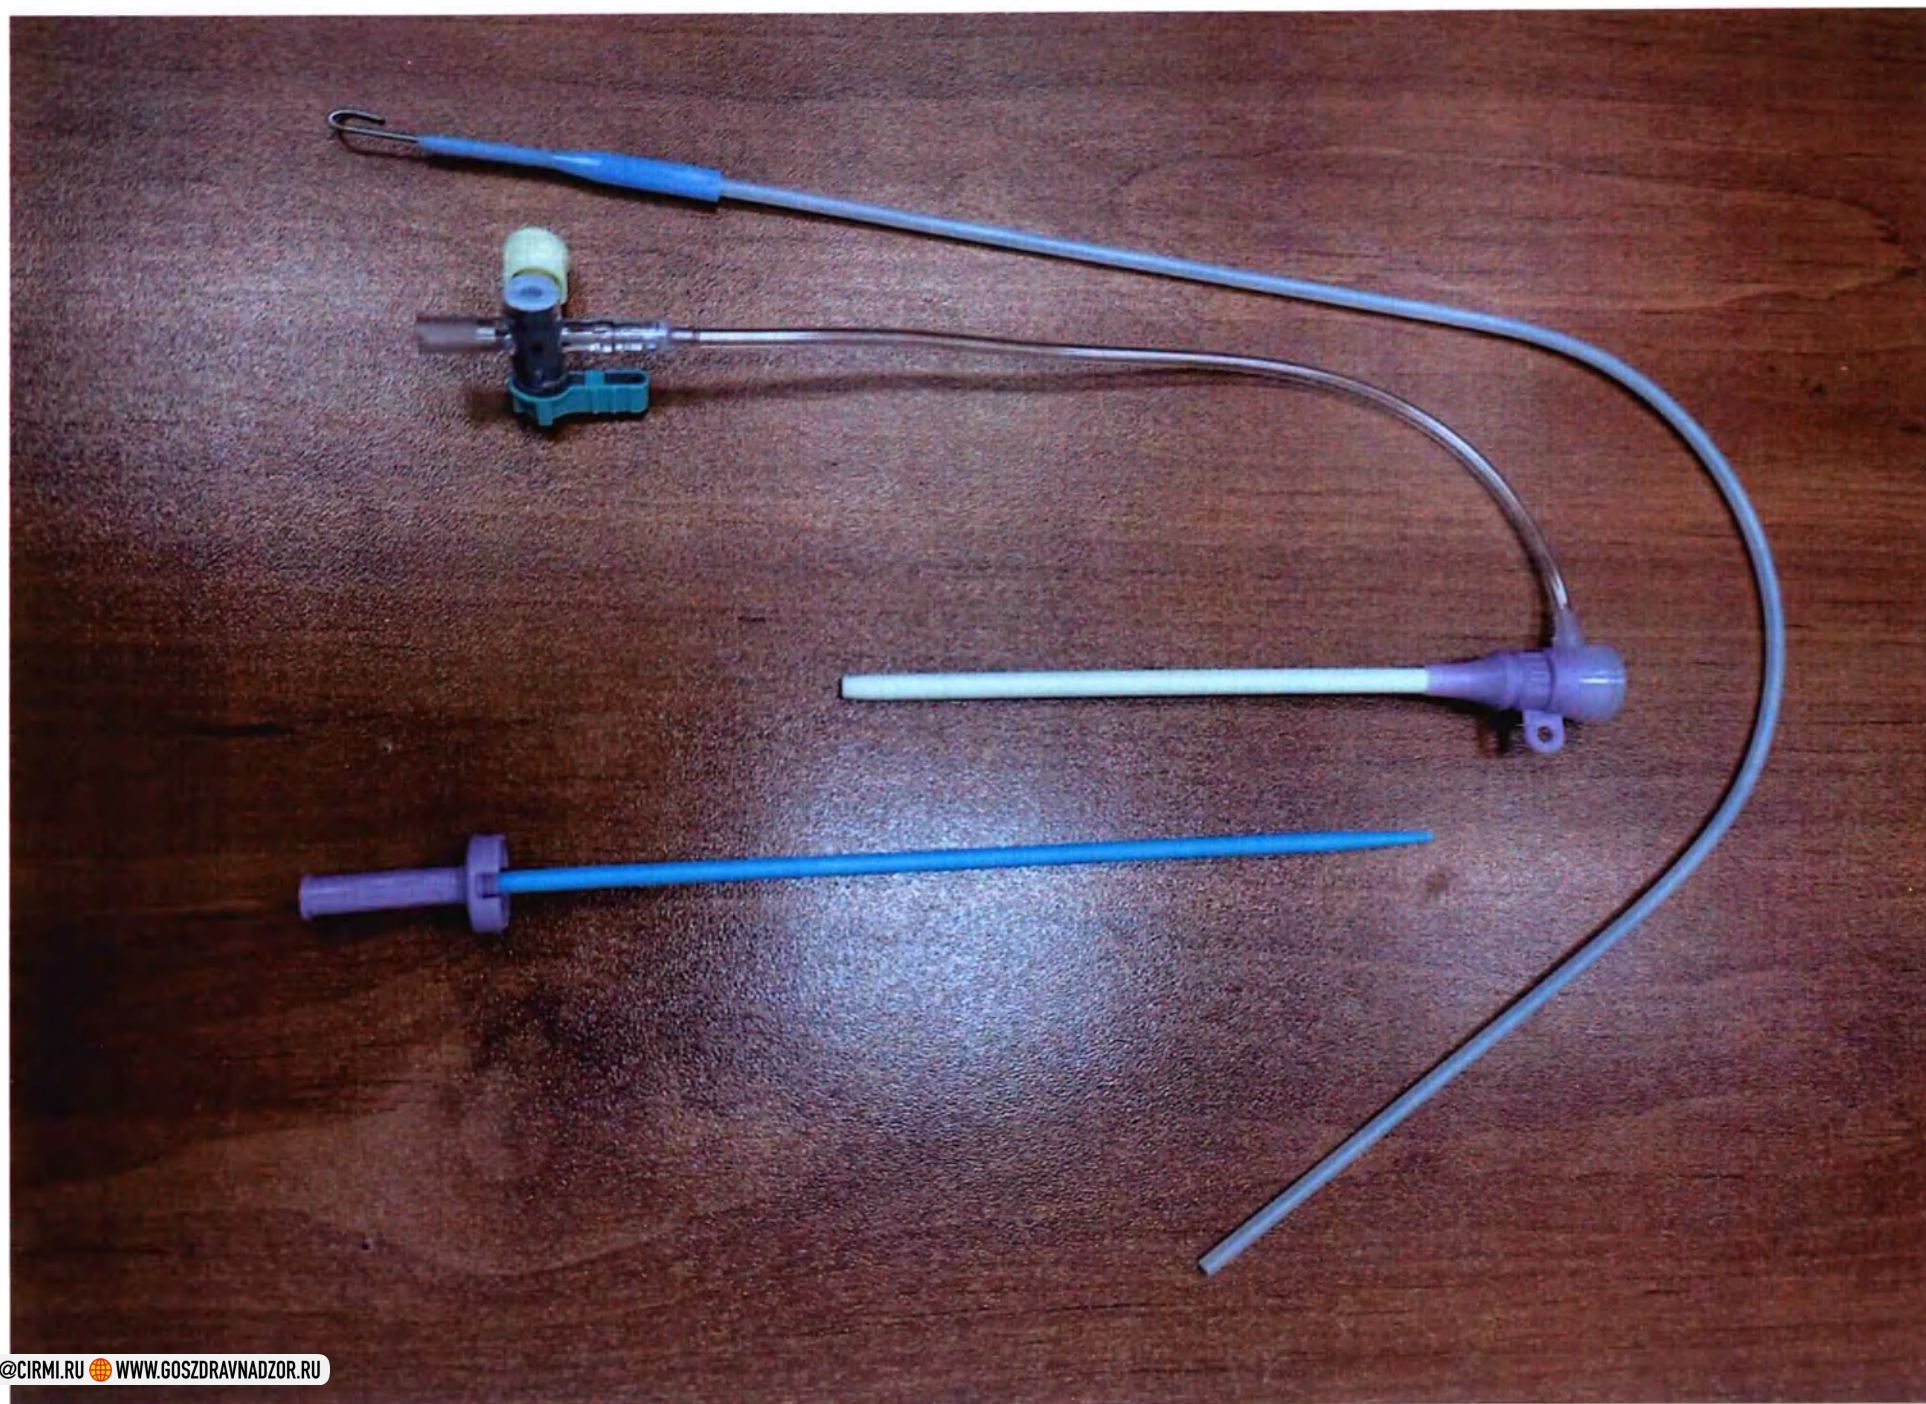


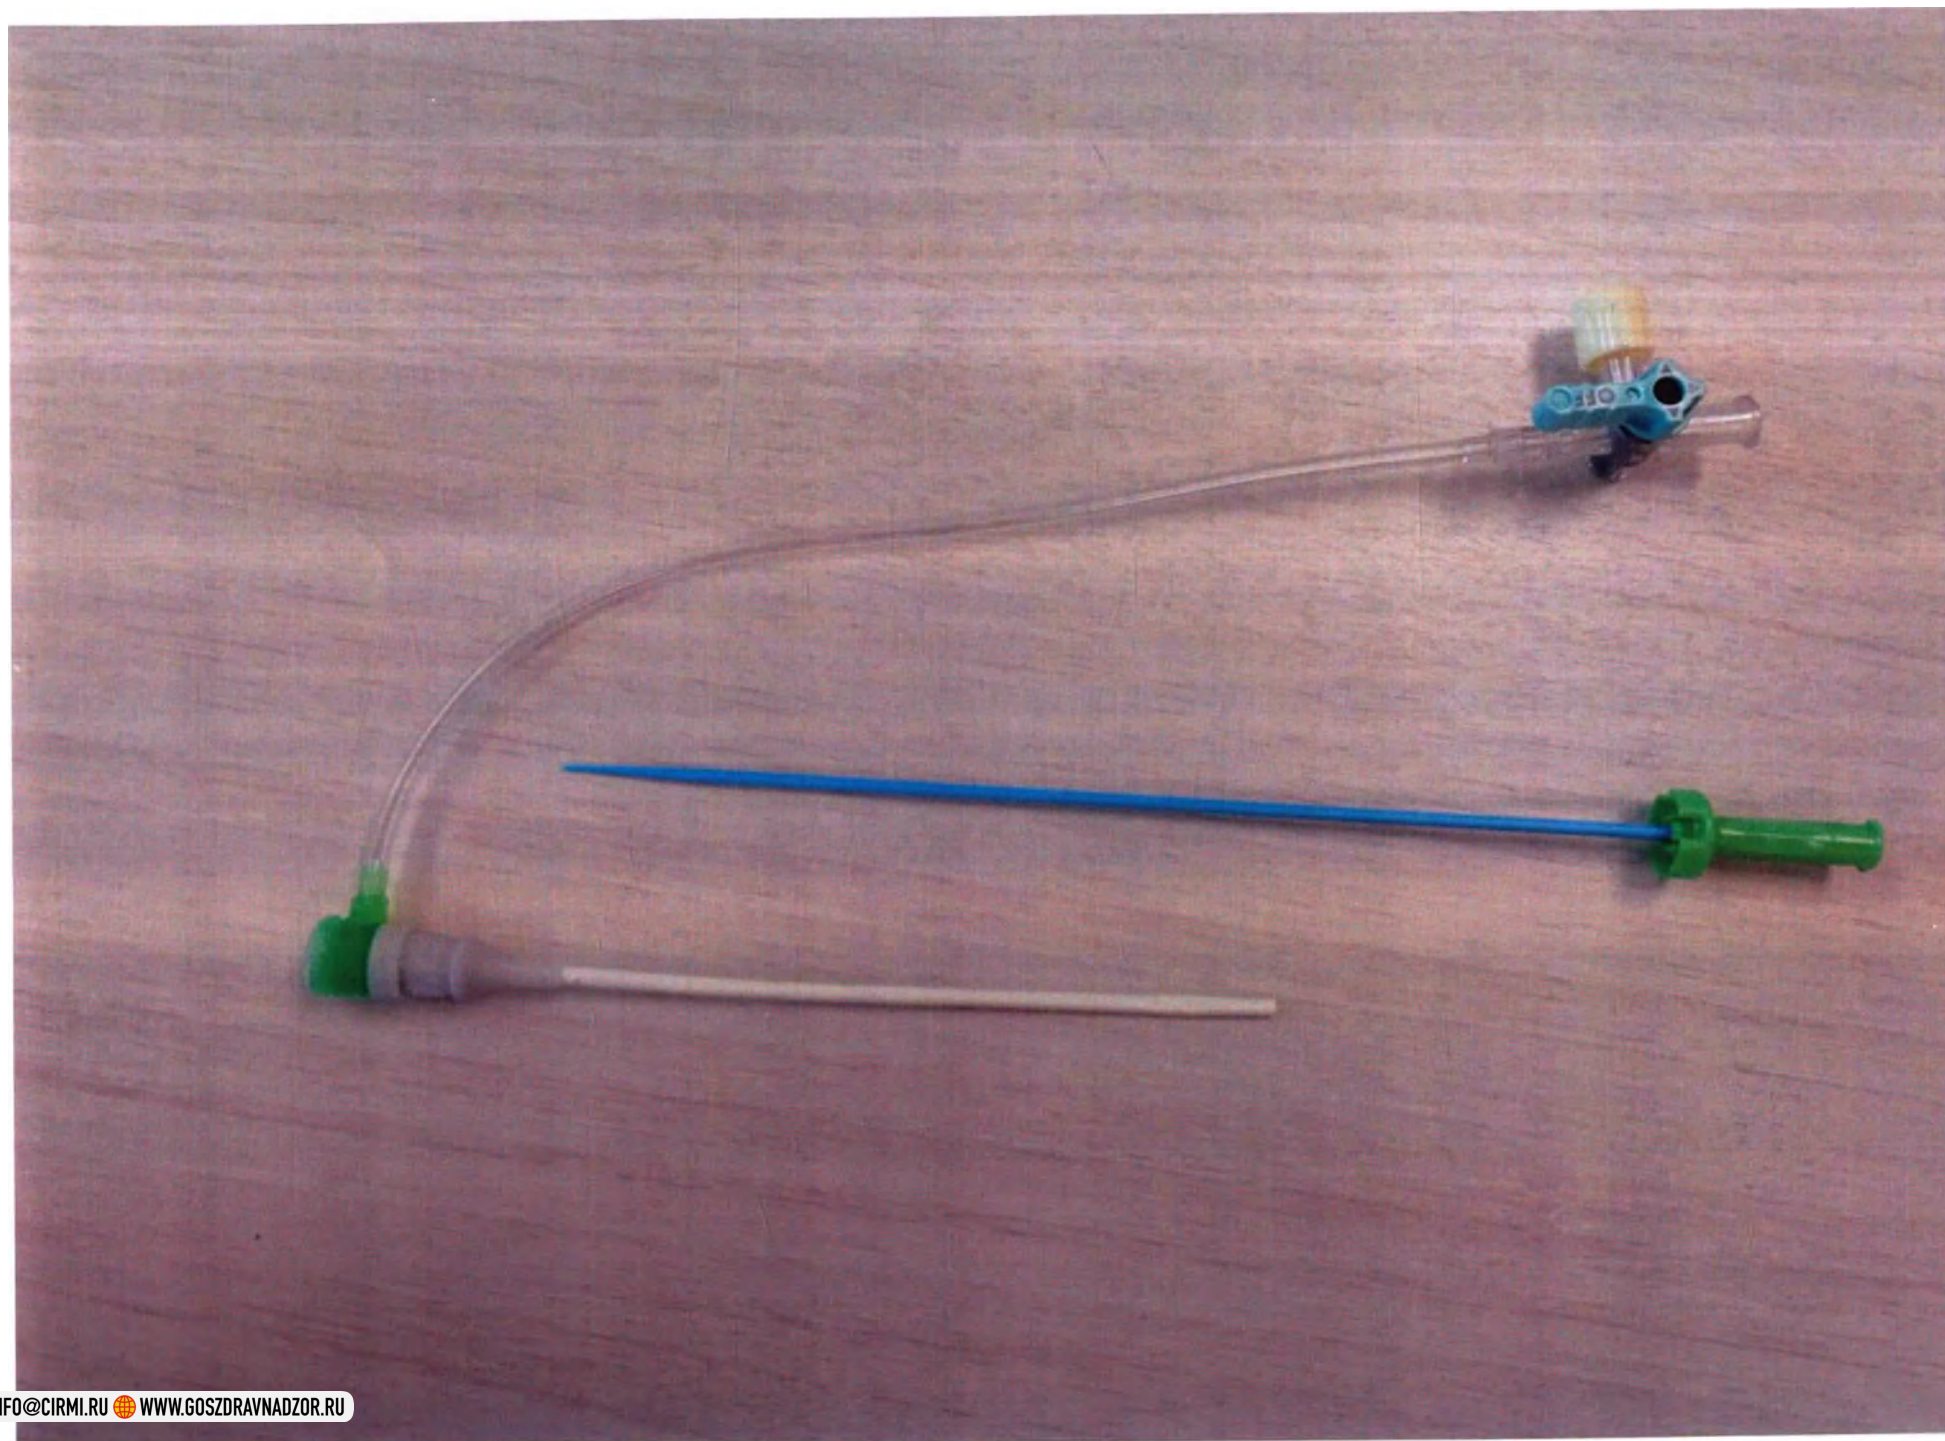


Интродюсер RADIFOCUS® INTRODUCER II (пример внешнего вида медицинского изделия в комплекте поставки: 1.Интродюсер; 2. Дилататор.
3. Мини проводник. 4. Металлическая пункционная игла. 5. Устройство для введения проводника.

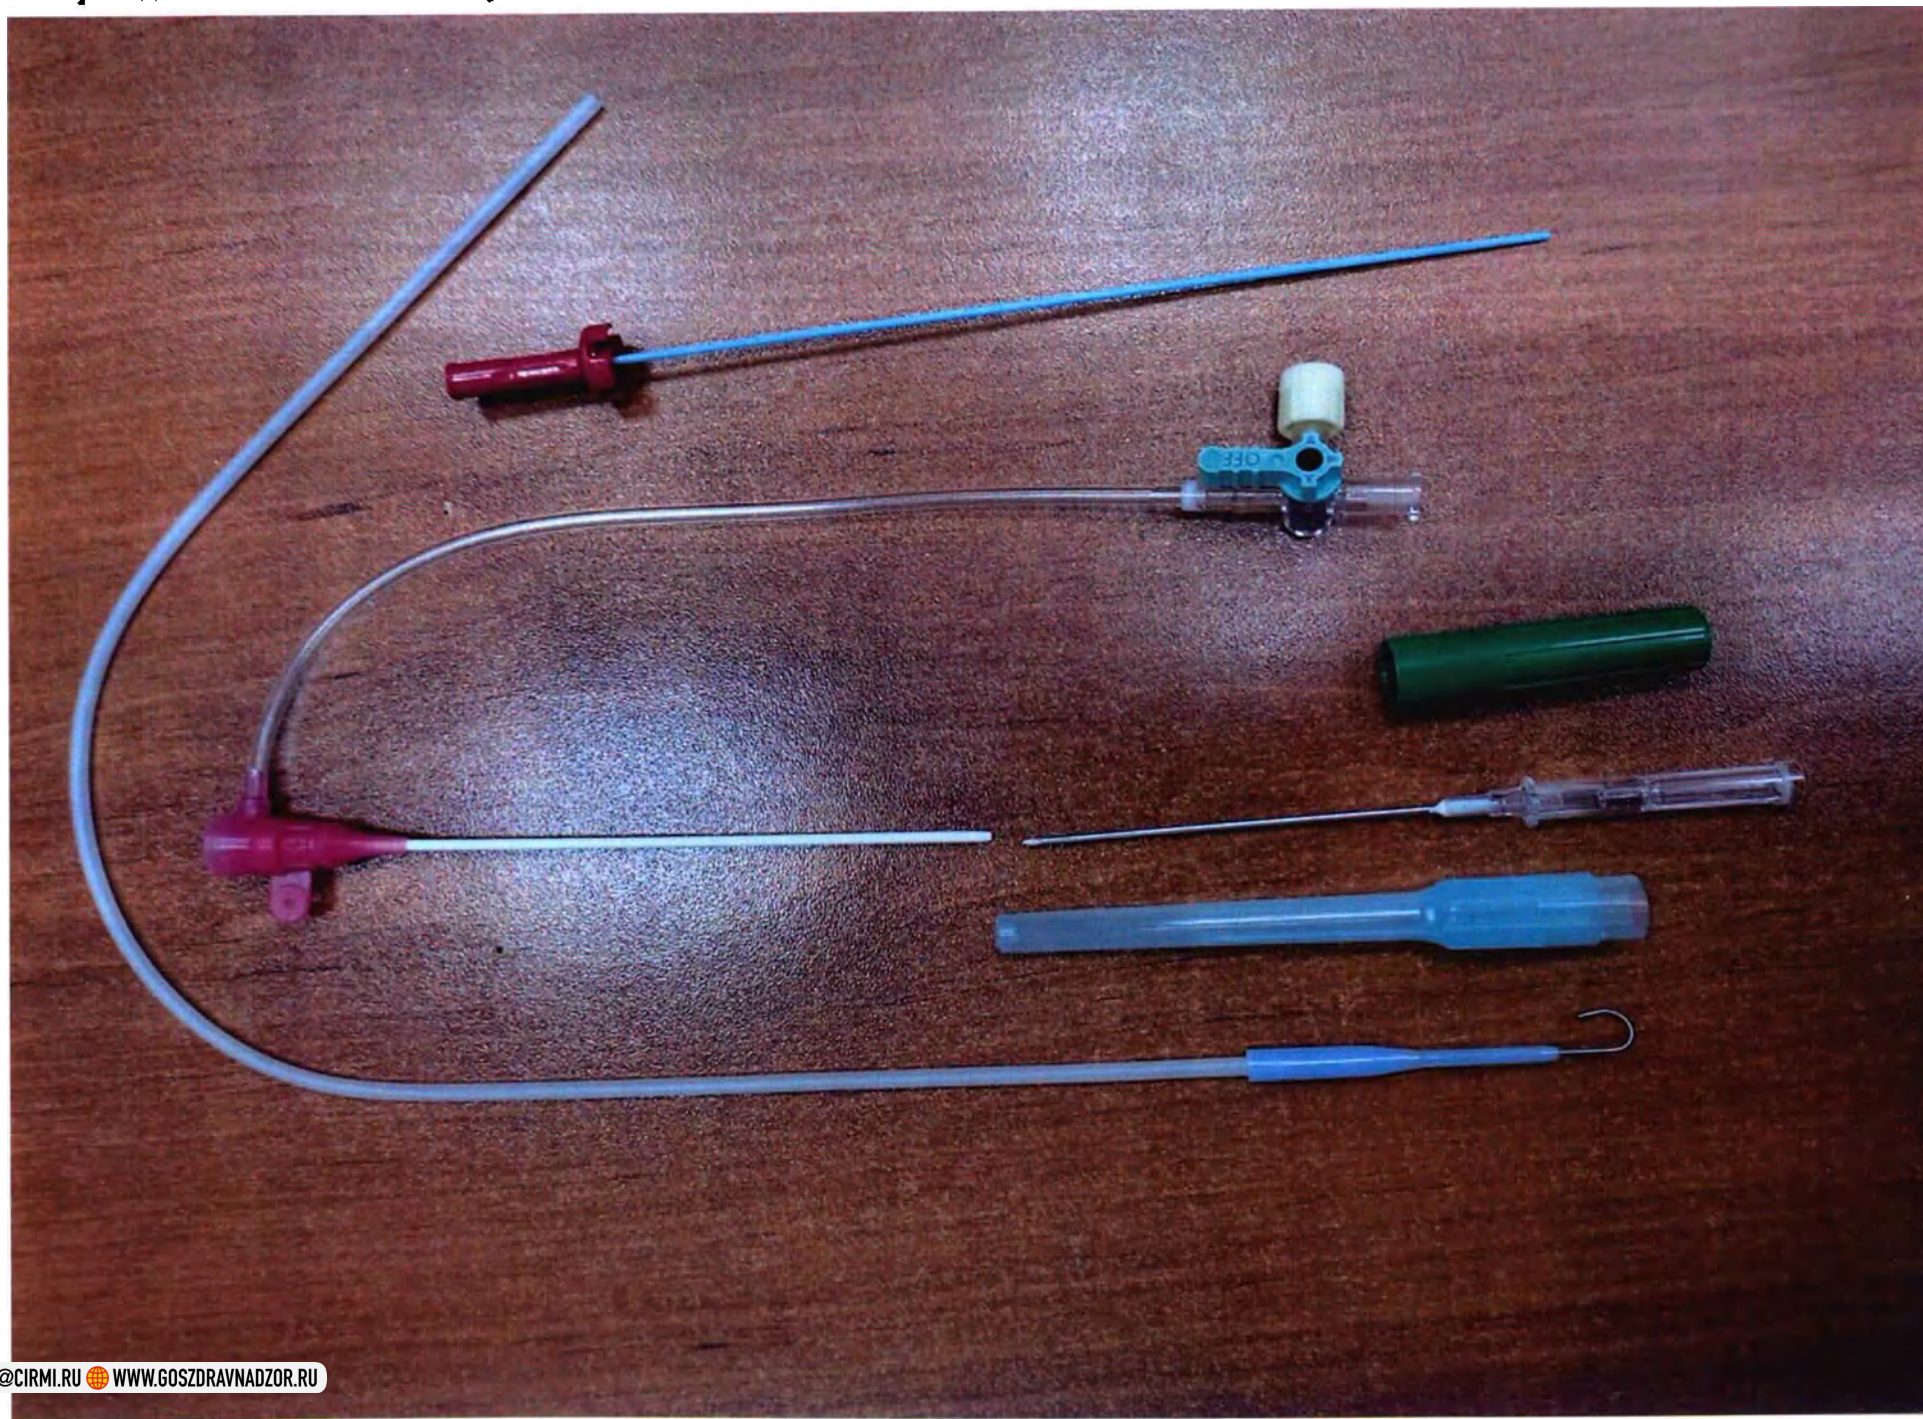


Интродьюсер RADIFOCUS® INTRODUCER II (пример внешнего вида медицинского изделия в комплекте поставки: 1. Интродьюсер.
2. Дилататор. 3. Мини проводник. 4. Шприц. 5. Пункционная игла с пластиковой канюлей 6. Скальпель.

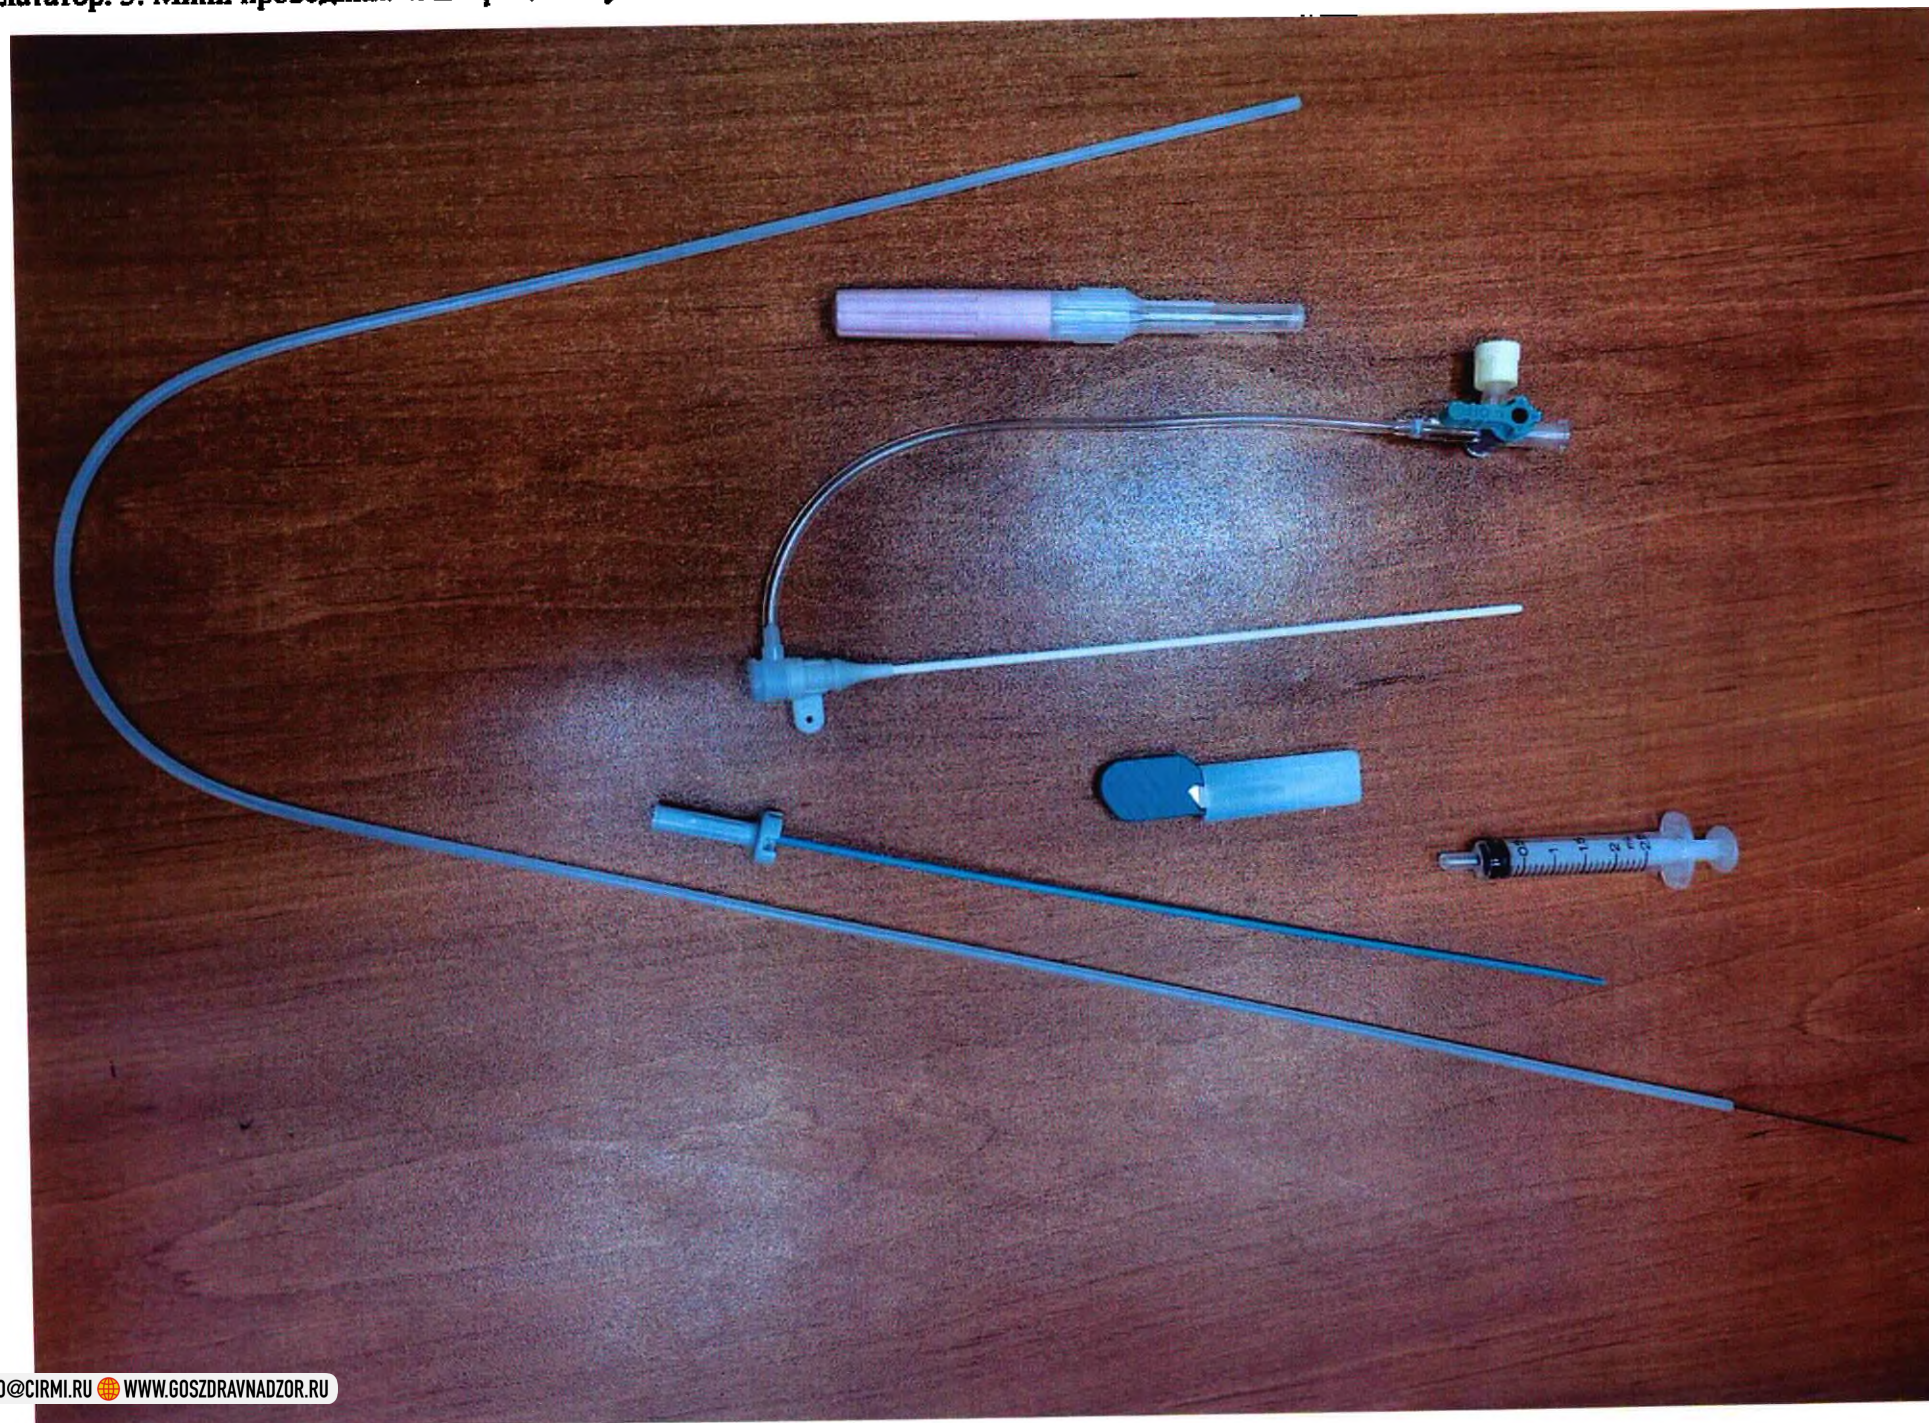


19
Интродьюсер RADIFOCUS® INTRODUCER II (пример внешнего вида медицинского изделия в комплекте поставки: 1. Интродьюсер.
2. Дилататор. 3. Мини проводник. 4. Шприц. 5. Пункционная игла с пластиковой канюлей 6. Скальпель. 7. Устройство для введения проводника.

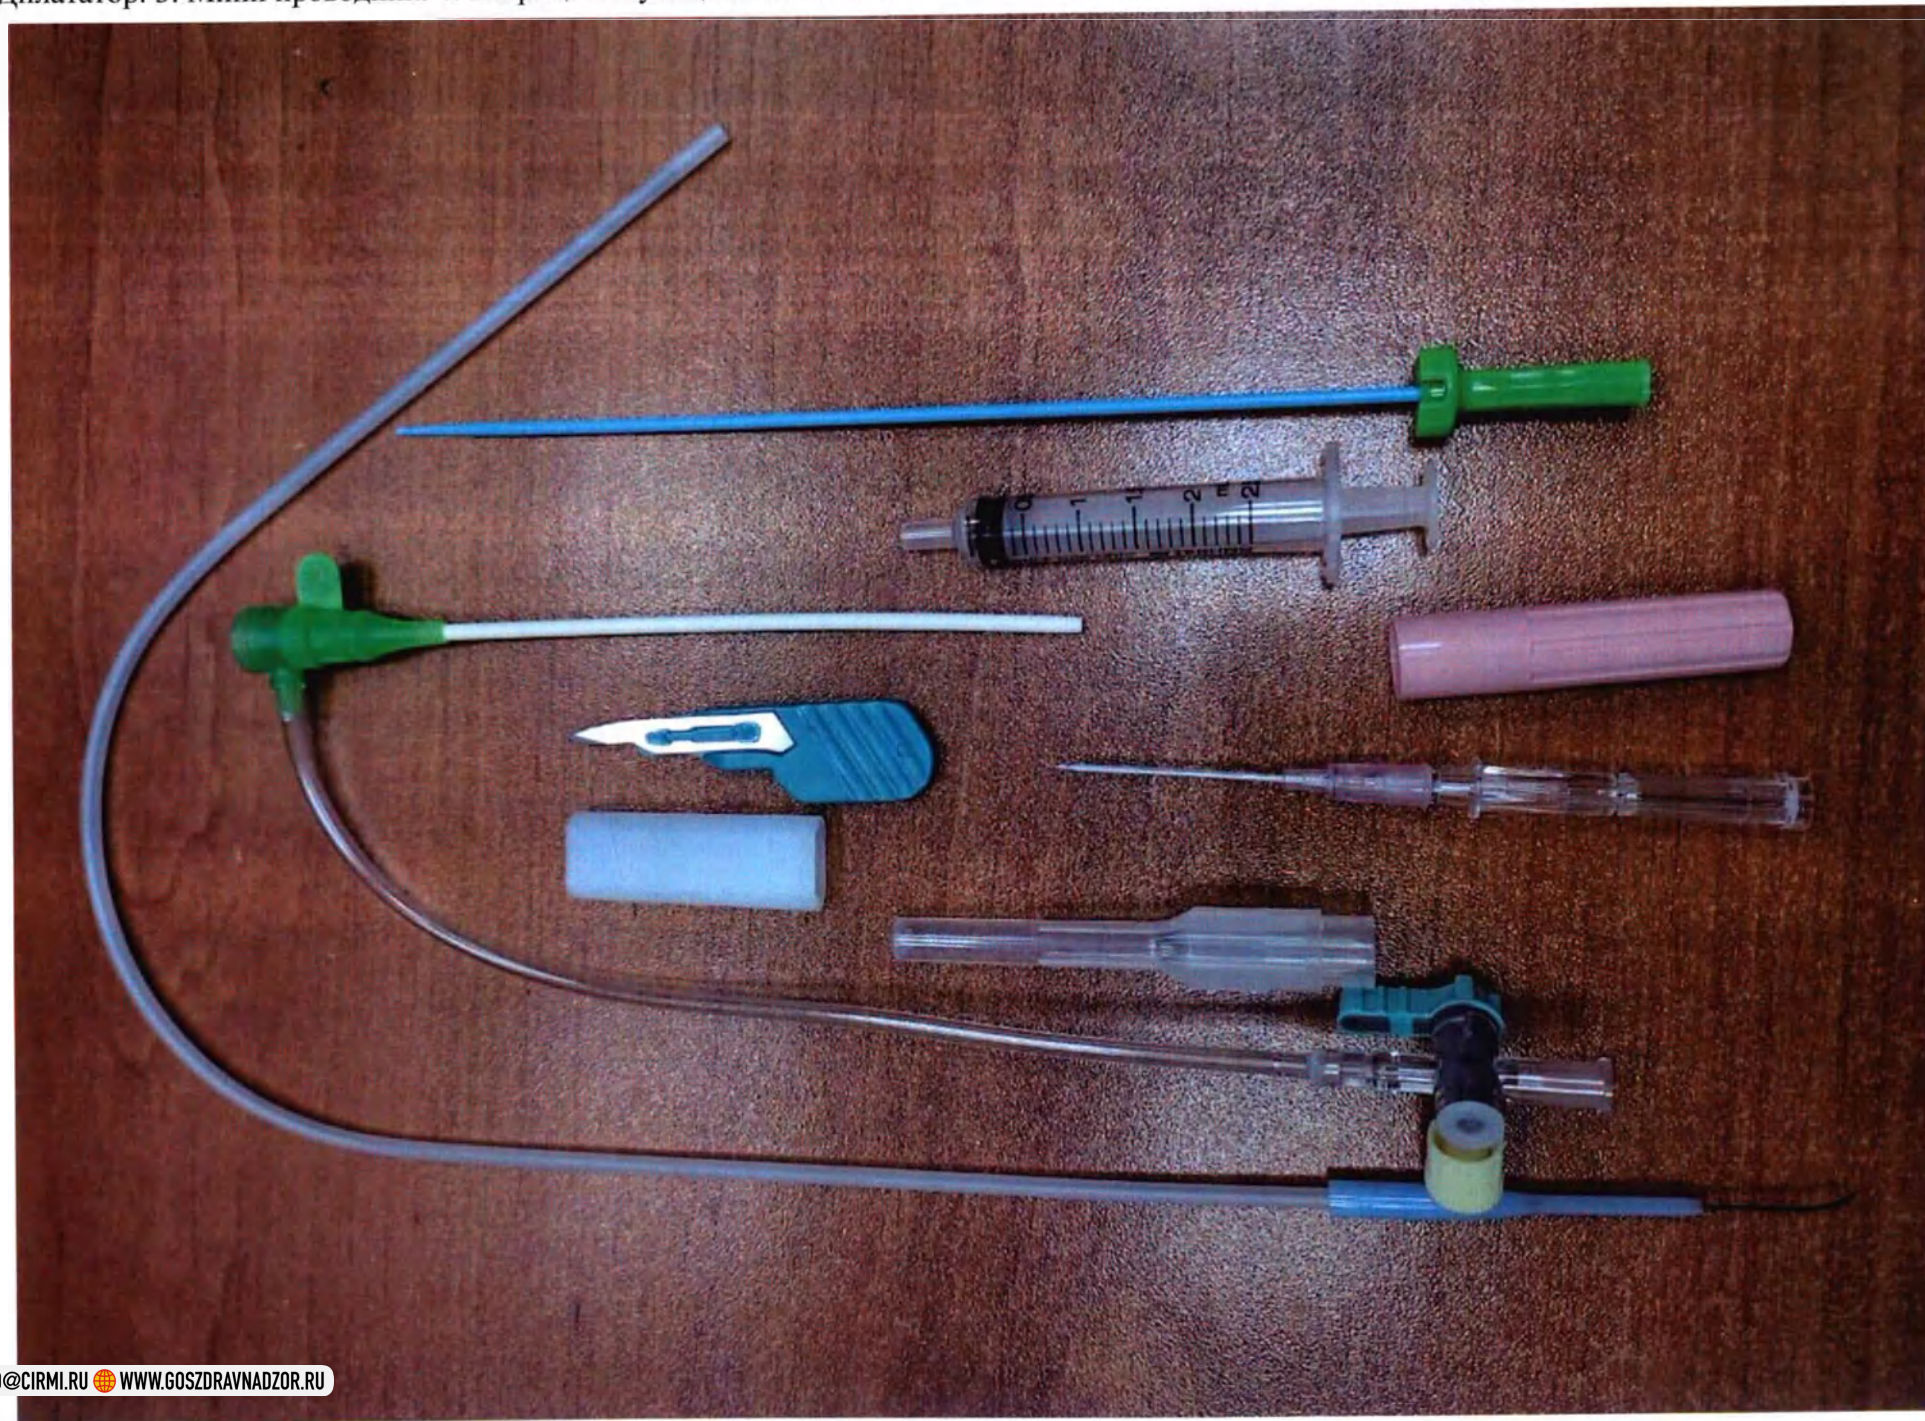

2. Дилататор.

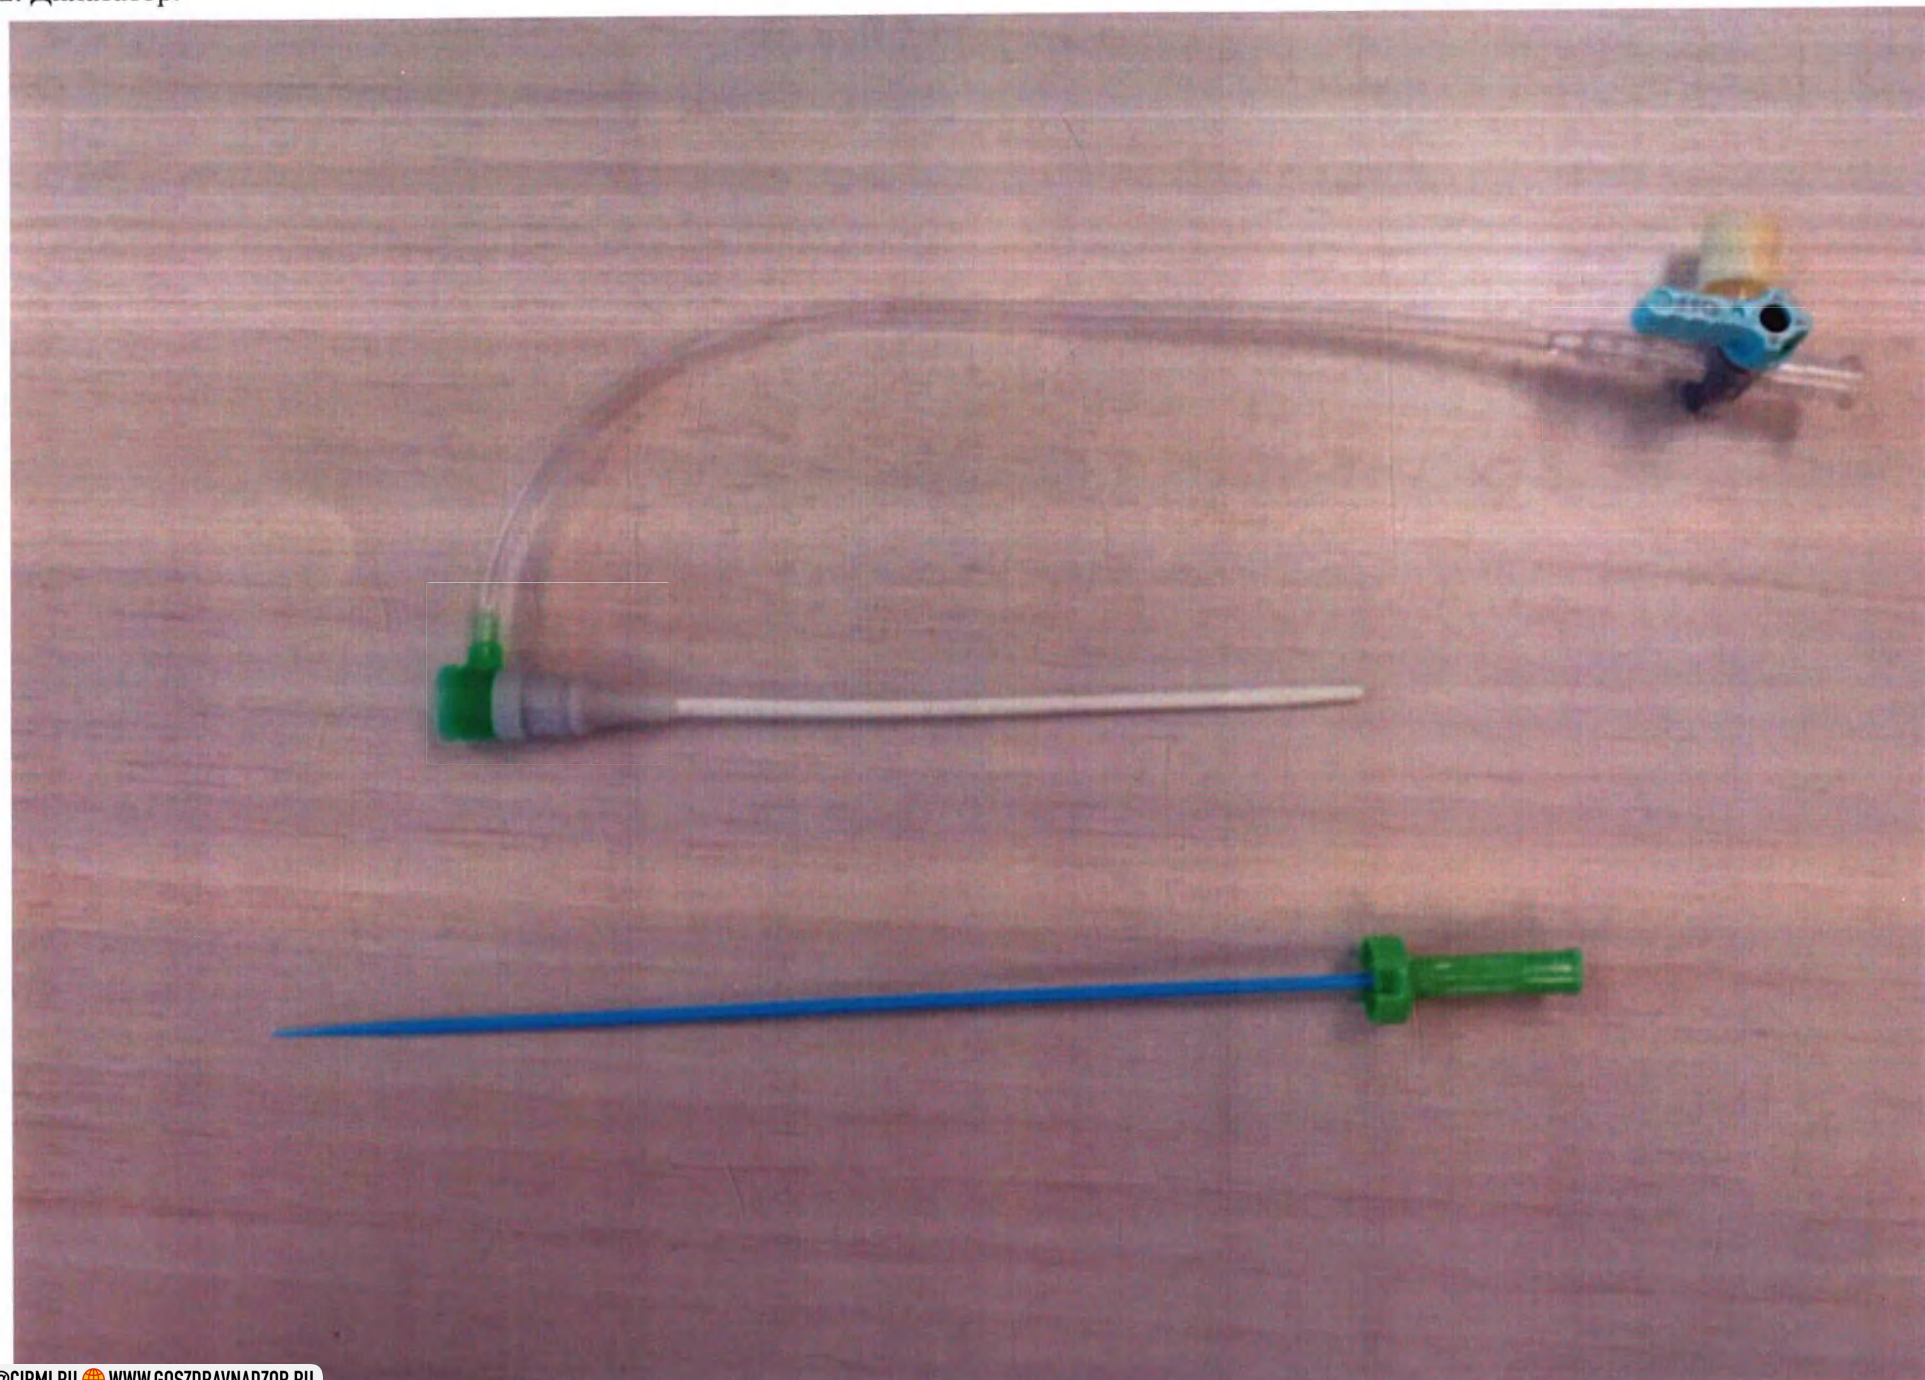

Интродьюсер RADIFOCUS® INTRODUCER II (пример внешнего вида медицинского изделия в комплекте поставки: 1. Интродьюсер. 2. Дилататор. 3. Мини проводник. 4. Металлическая пункционная игла

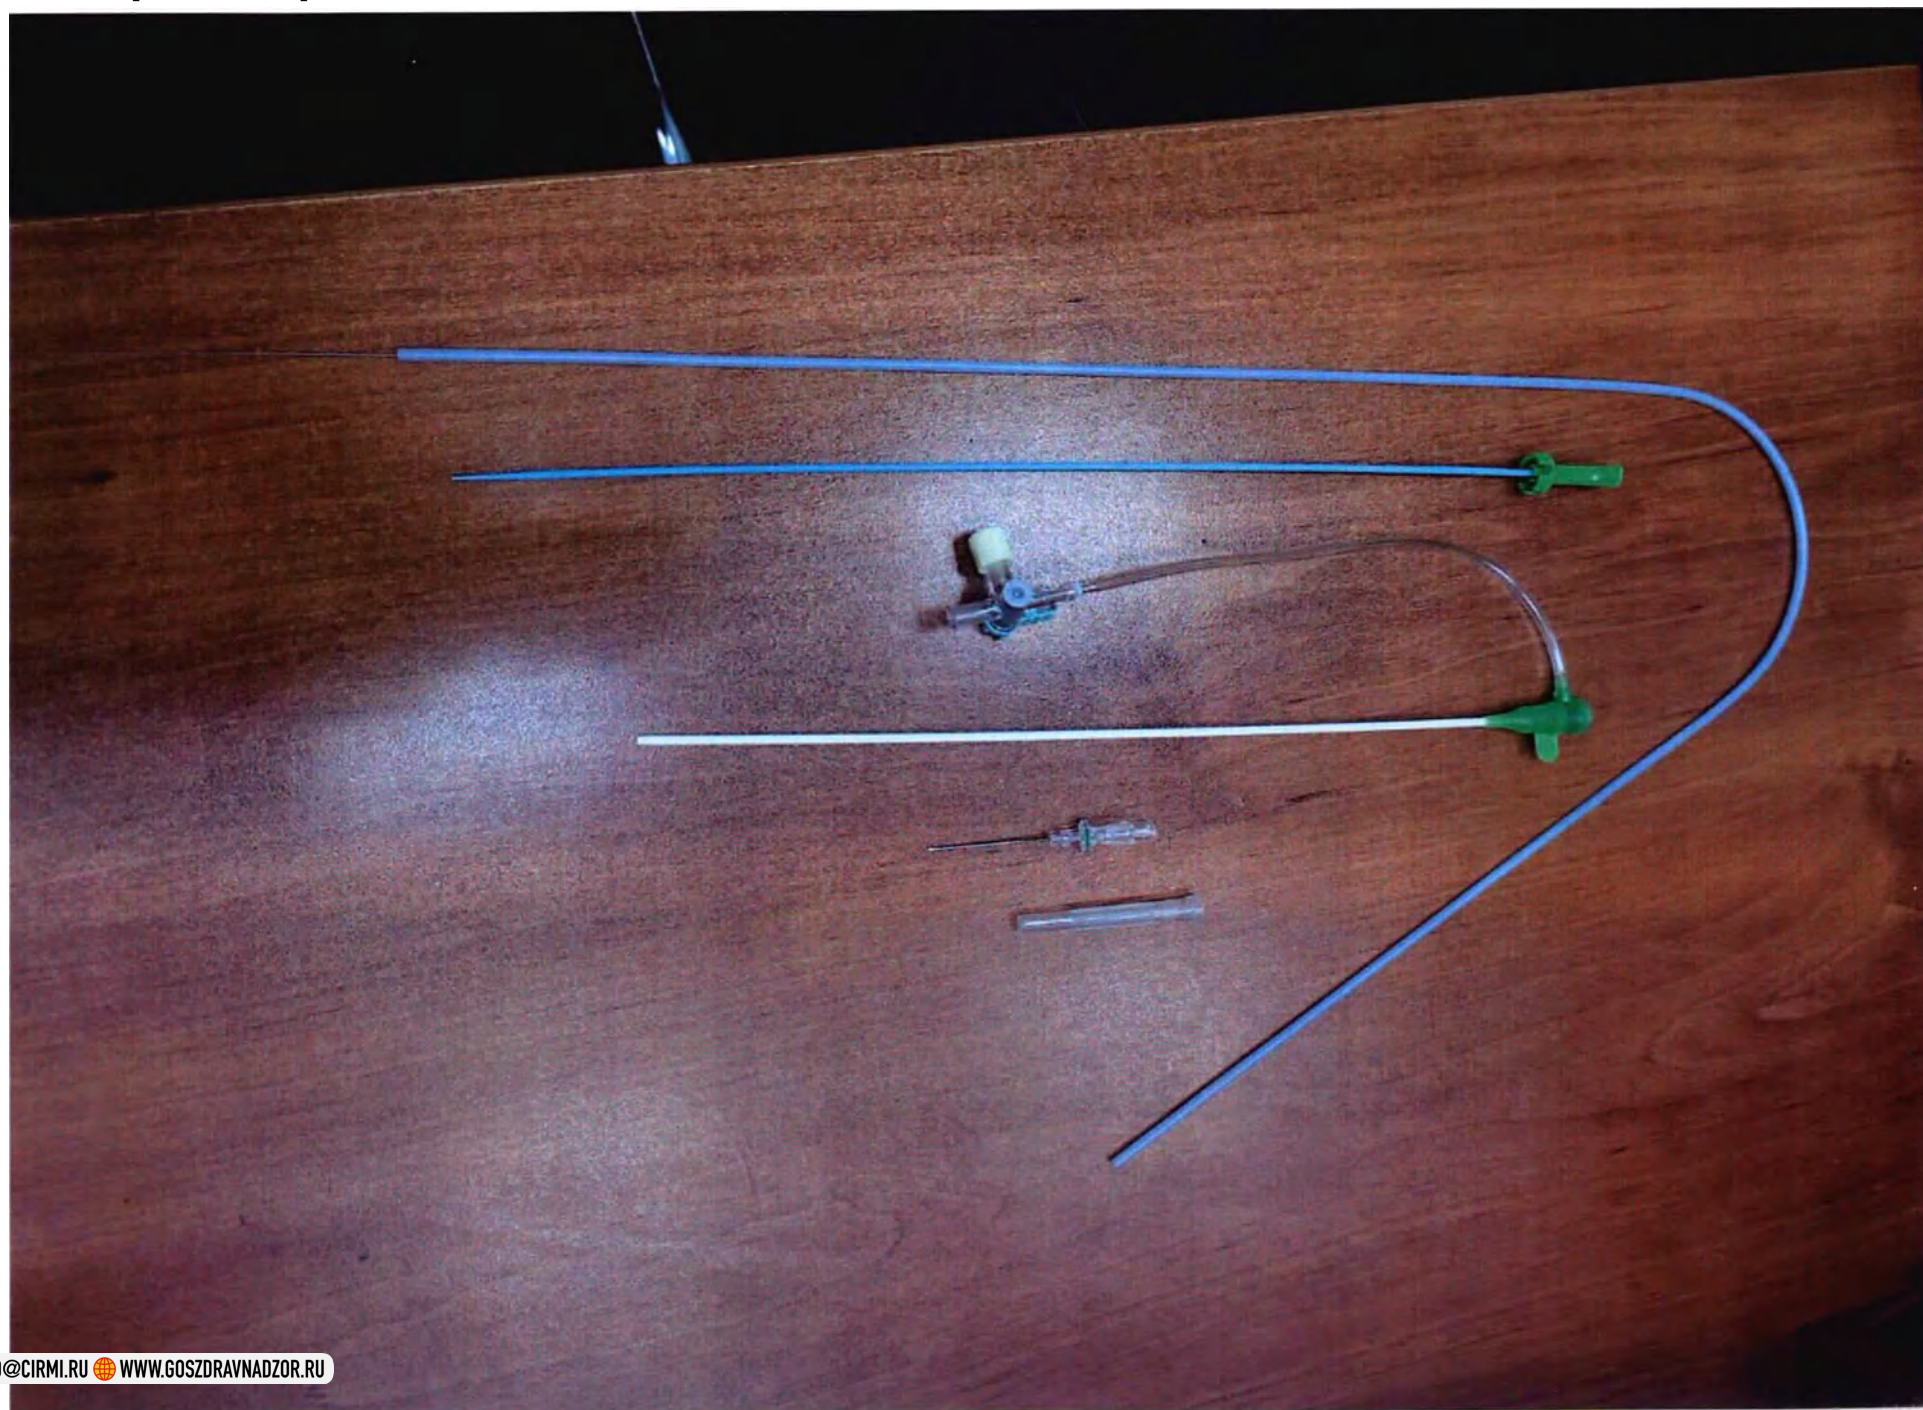

ПРОШТО И
ПРОНУМЕРАНО
НА 17 ЛИСТАХ

