

«УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель направления по регистрации продукции
для диагностической визуализации,
высокотехнологичной терапии и ультразвуковой диагностики

ООО «Сименс Здравоохранение»




Е.С. Тисленко

«15» июня 2022 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

Система рентгенодиагностическая цифровая для урологии и лечения Urooskop Omnia Max в
исполнениях с принадлежностями

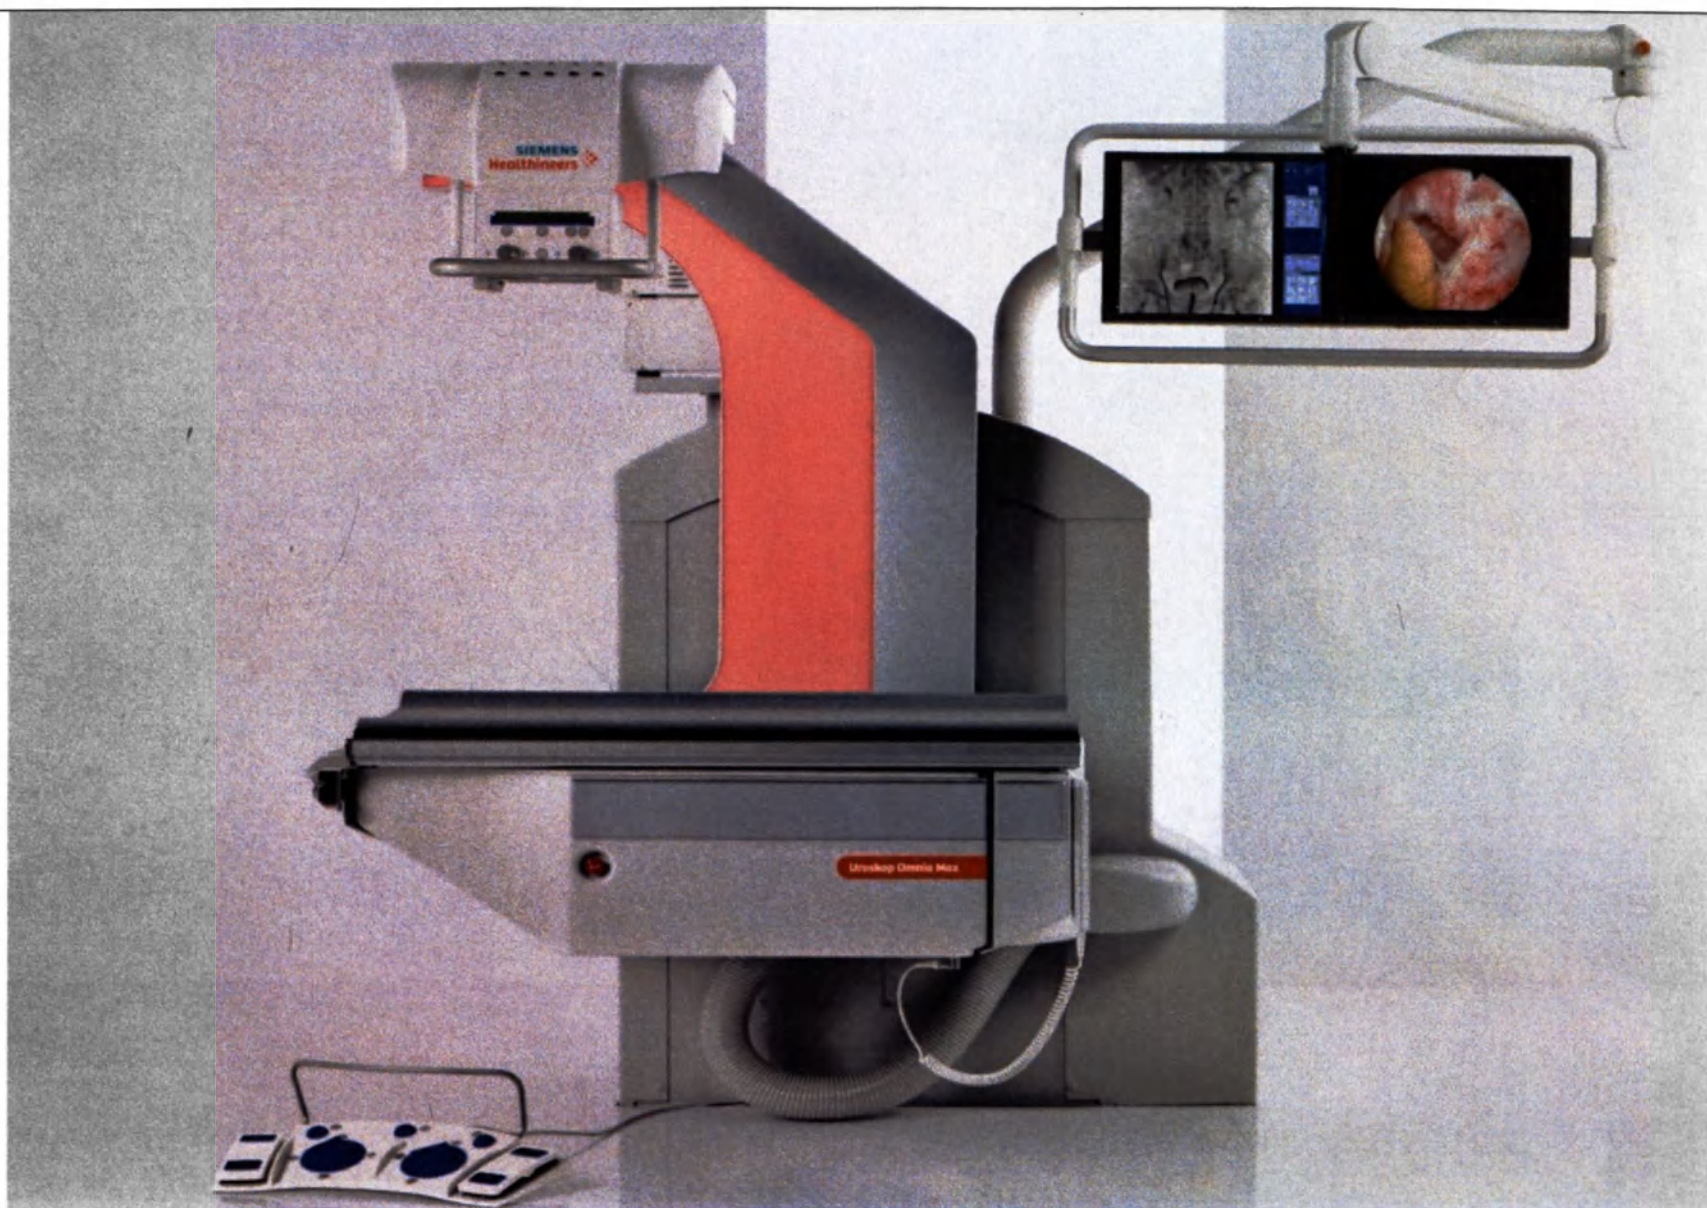

Общий вид медицинского изделия «Система рентгенодиагностическая цифровая для урологии и лечения Uroscop Omnia Max в исполнениях с принадлежностями»

Система рентгенодиагностическая цифровая для урологии и лечения «Uroskor Omnia Max» в исполнениях с принадлежностями

Регистрационное удостоверение: РЗН 2017/5444 от дд.мм.гггг

Страна производства: Германия

Дата производства и серийный номер указаны на основной маркировке изделия

**Назначение; нормативная документация, требованиям которой соответствует
медицинское изделие; массогабаритные характеристики и срок службы изделия
указаны в документации пользователя**

Уполномоченный представитель производителя:

ООО «Сименс Здравоохранение», 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д.96

~ 3/PE 380/400/440/480 В

50/60 Гц

126 кВА / 0,7 кВА

Макет маркировки медицинского изделия на русском языке

Uroskop Omnia Max



(01) 04056869008981 GTIN

(240) 10762473

(422) 276

(21) 6096


MODEL

ORIGIN DE

SERIAL



0123



2021

SYSTEM IVK




Siemens Healthcare GmbH, Henkestr. 127
91052 Erlangen, Germany

Made in Germany


10762473

Маркировка медицинского изделия «Система рентгенодиагностическая цифровая для урологии и лечения Uroskop Omnia Max в исполнениях с принадлежностями»


I. «Система рентгенодиагностическая цифровая для урологии и лечения Uroskor Omnia Max в исполнениях с принадлежностями» (Базовый блок):

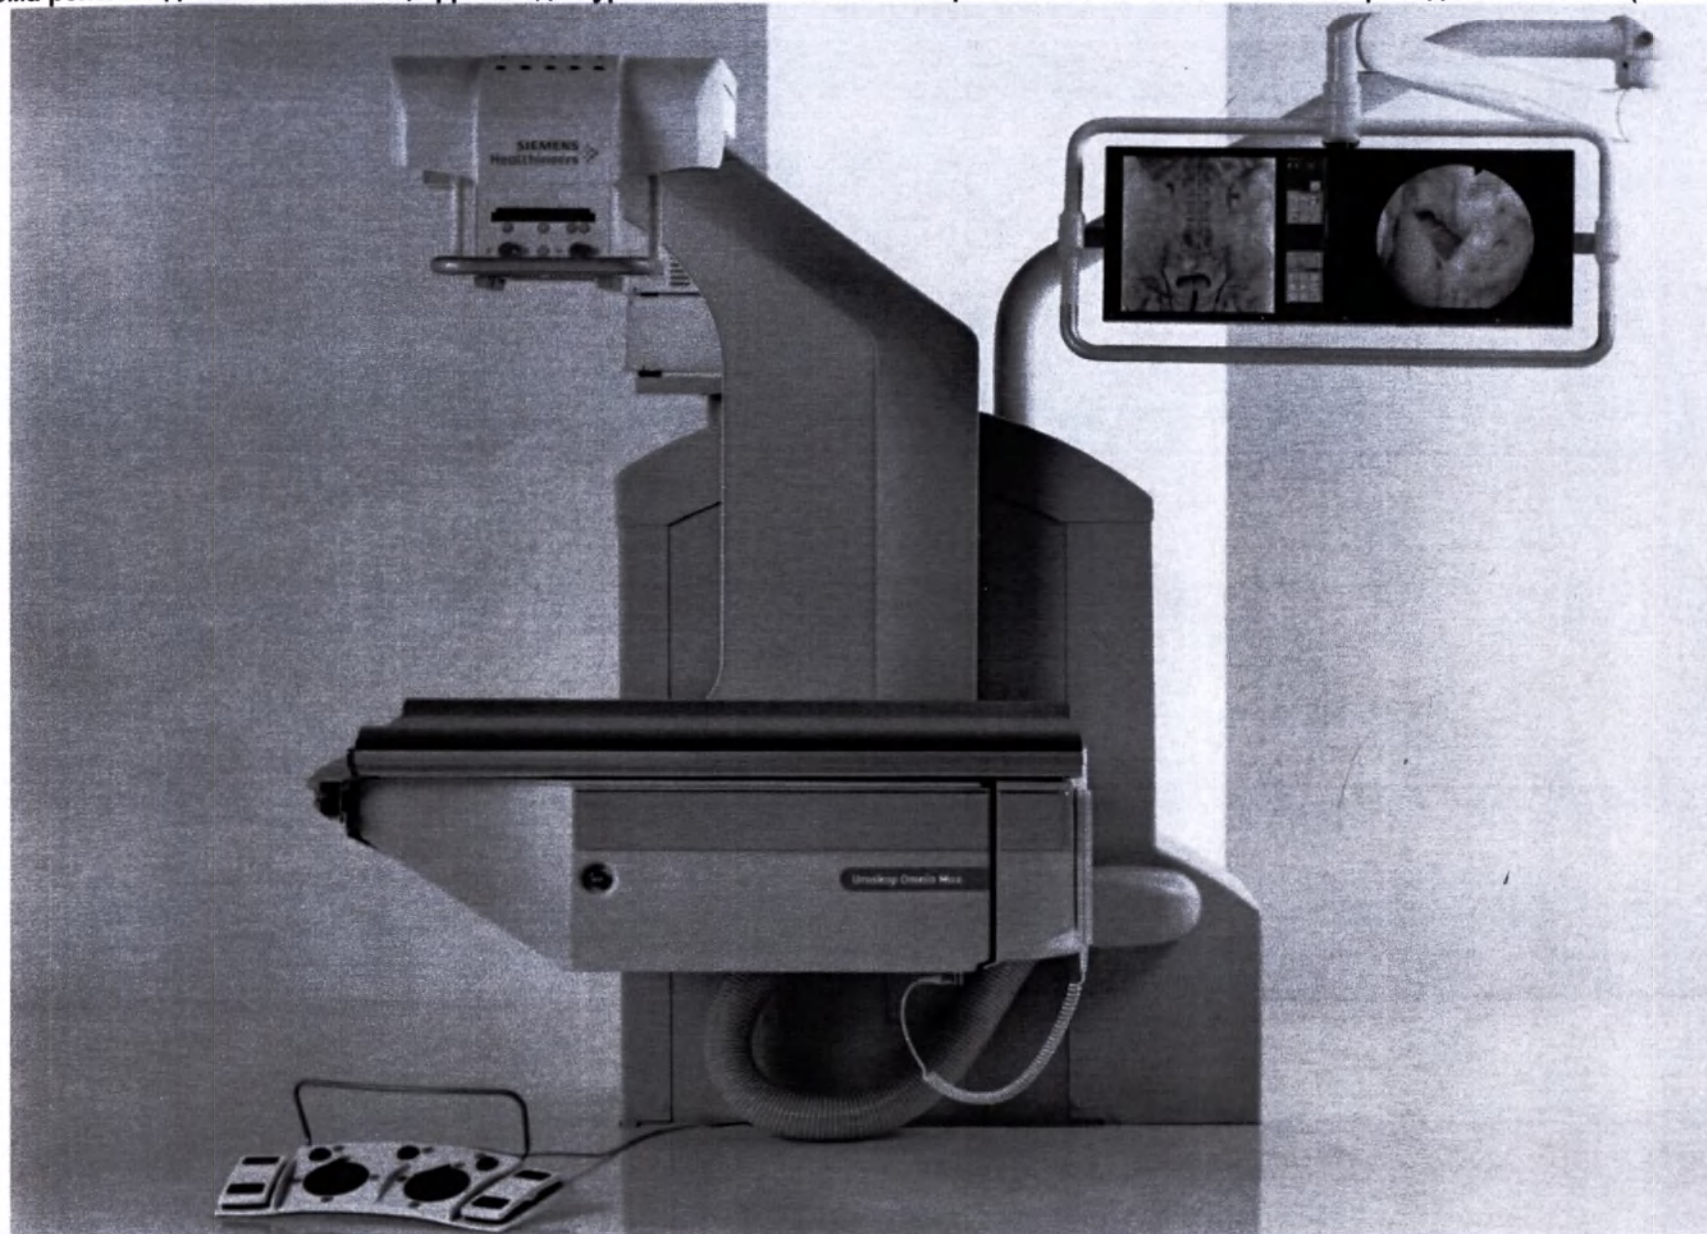


1. Штатив левосторонний с рентгеновской трубкой

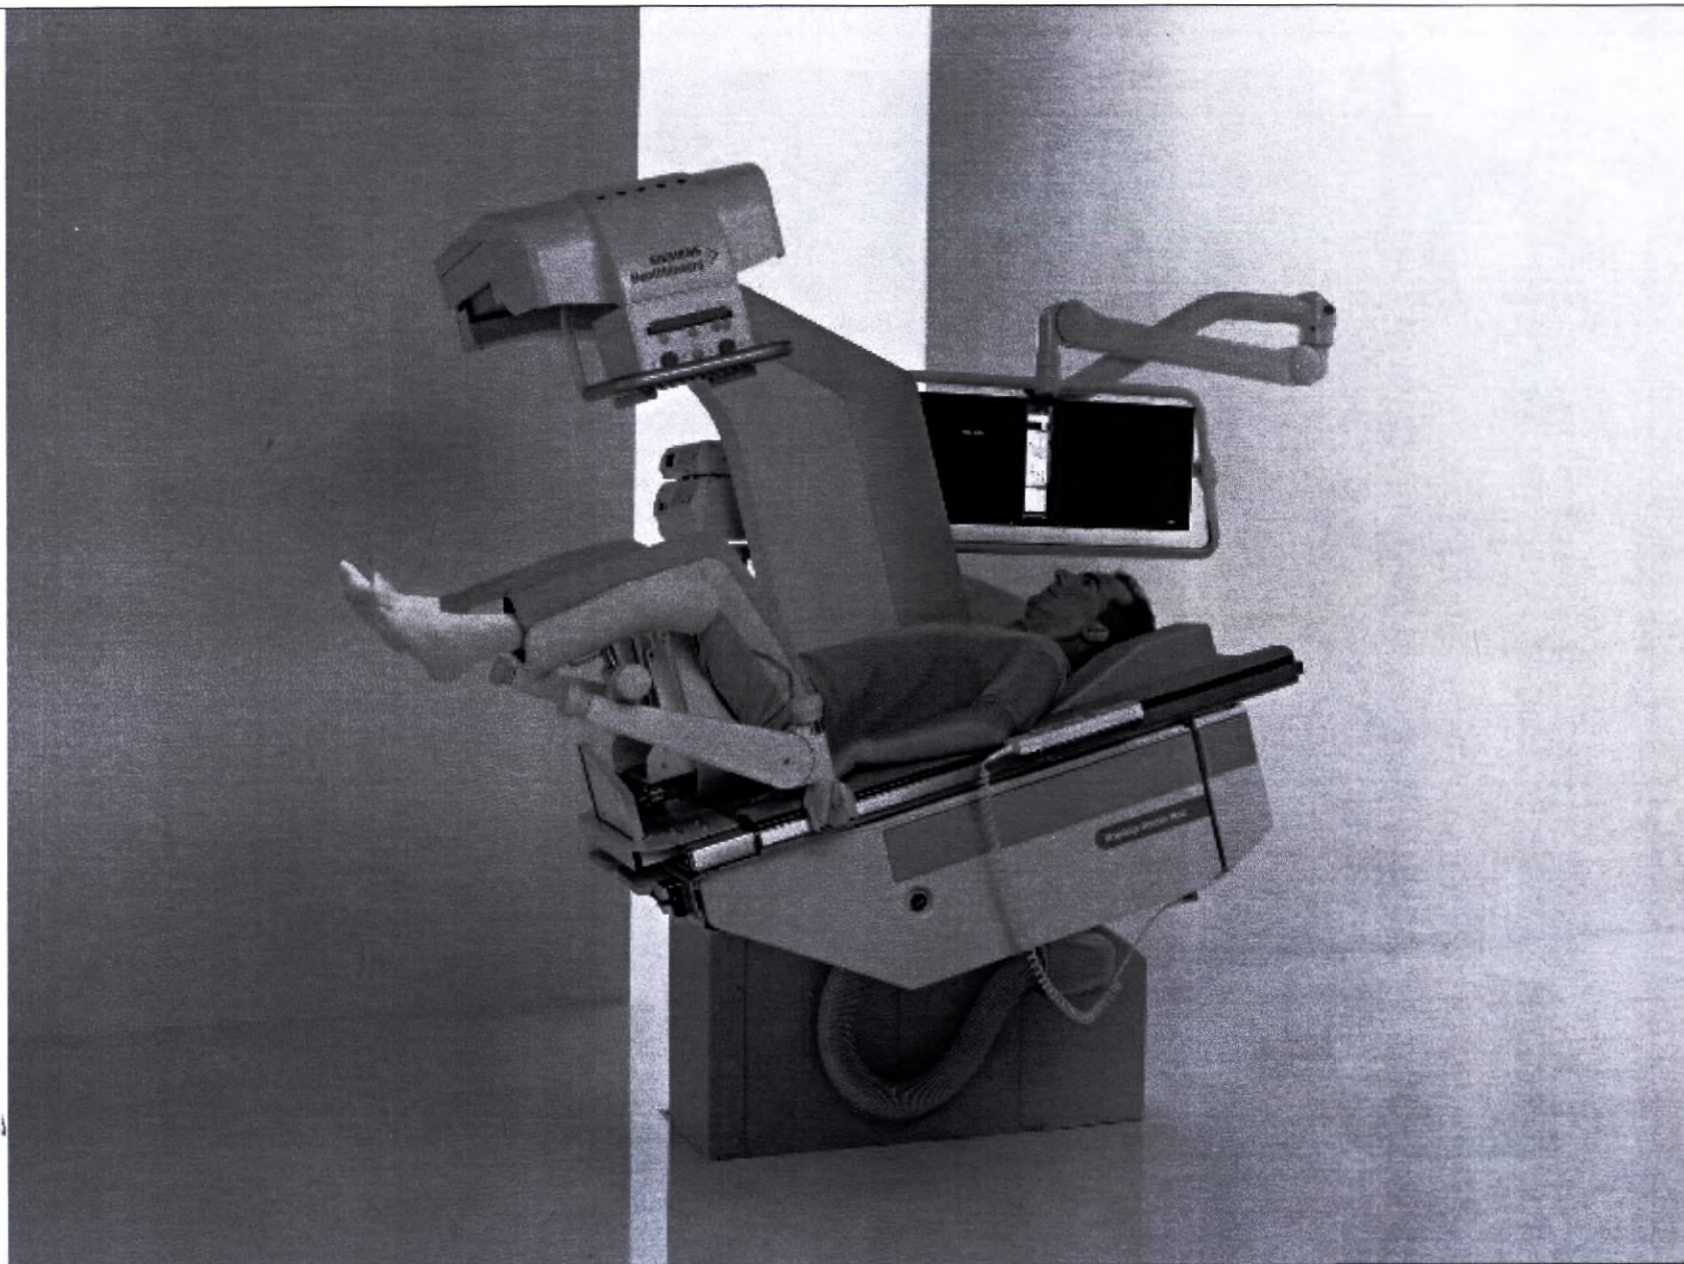

2. Стол и дека стола пациента

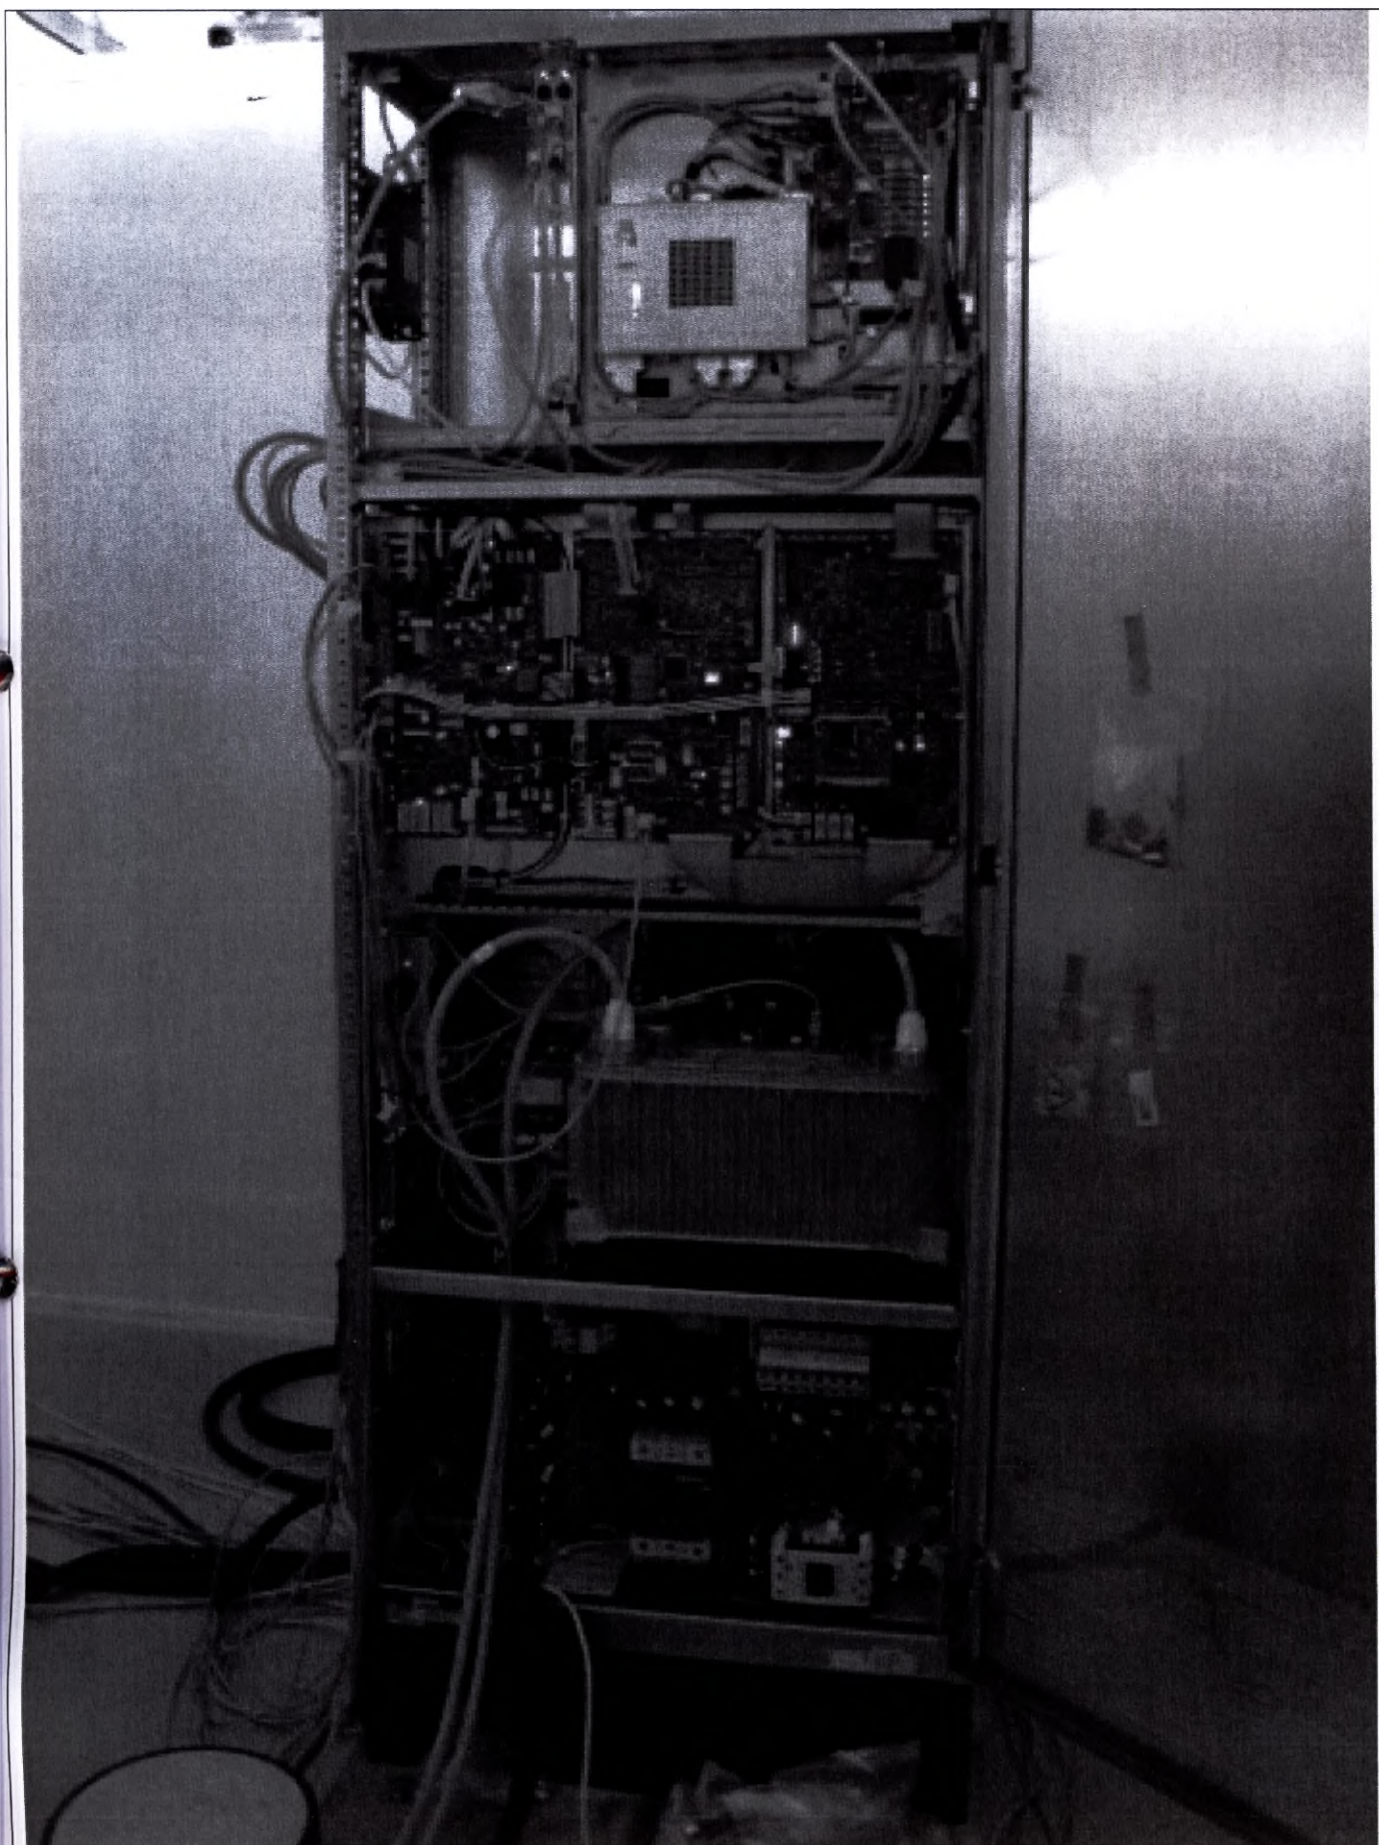

3. Генератор рентгеновского излучения, варианты исполнения: POLYDOROS F65, POLYDOROS F80.

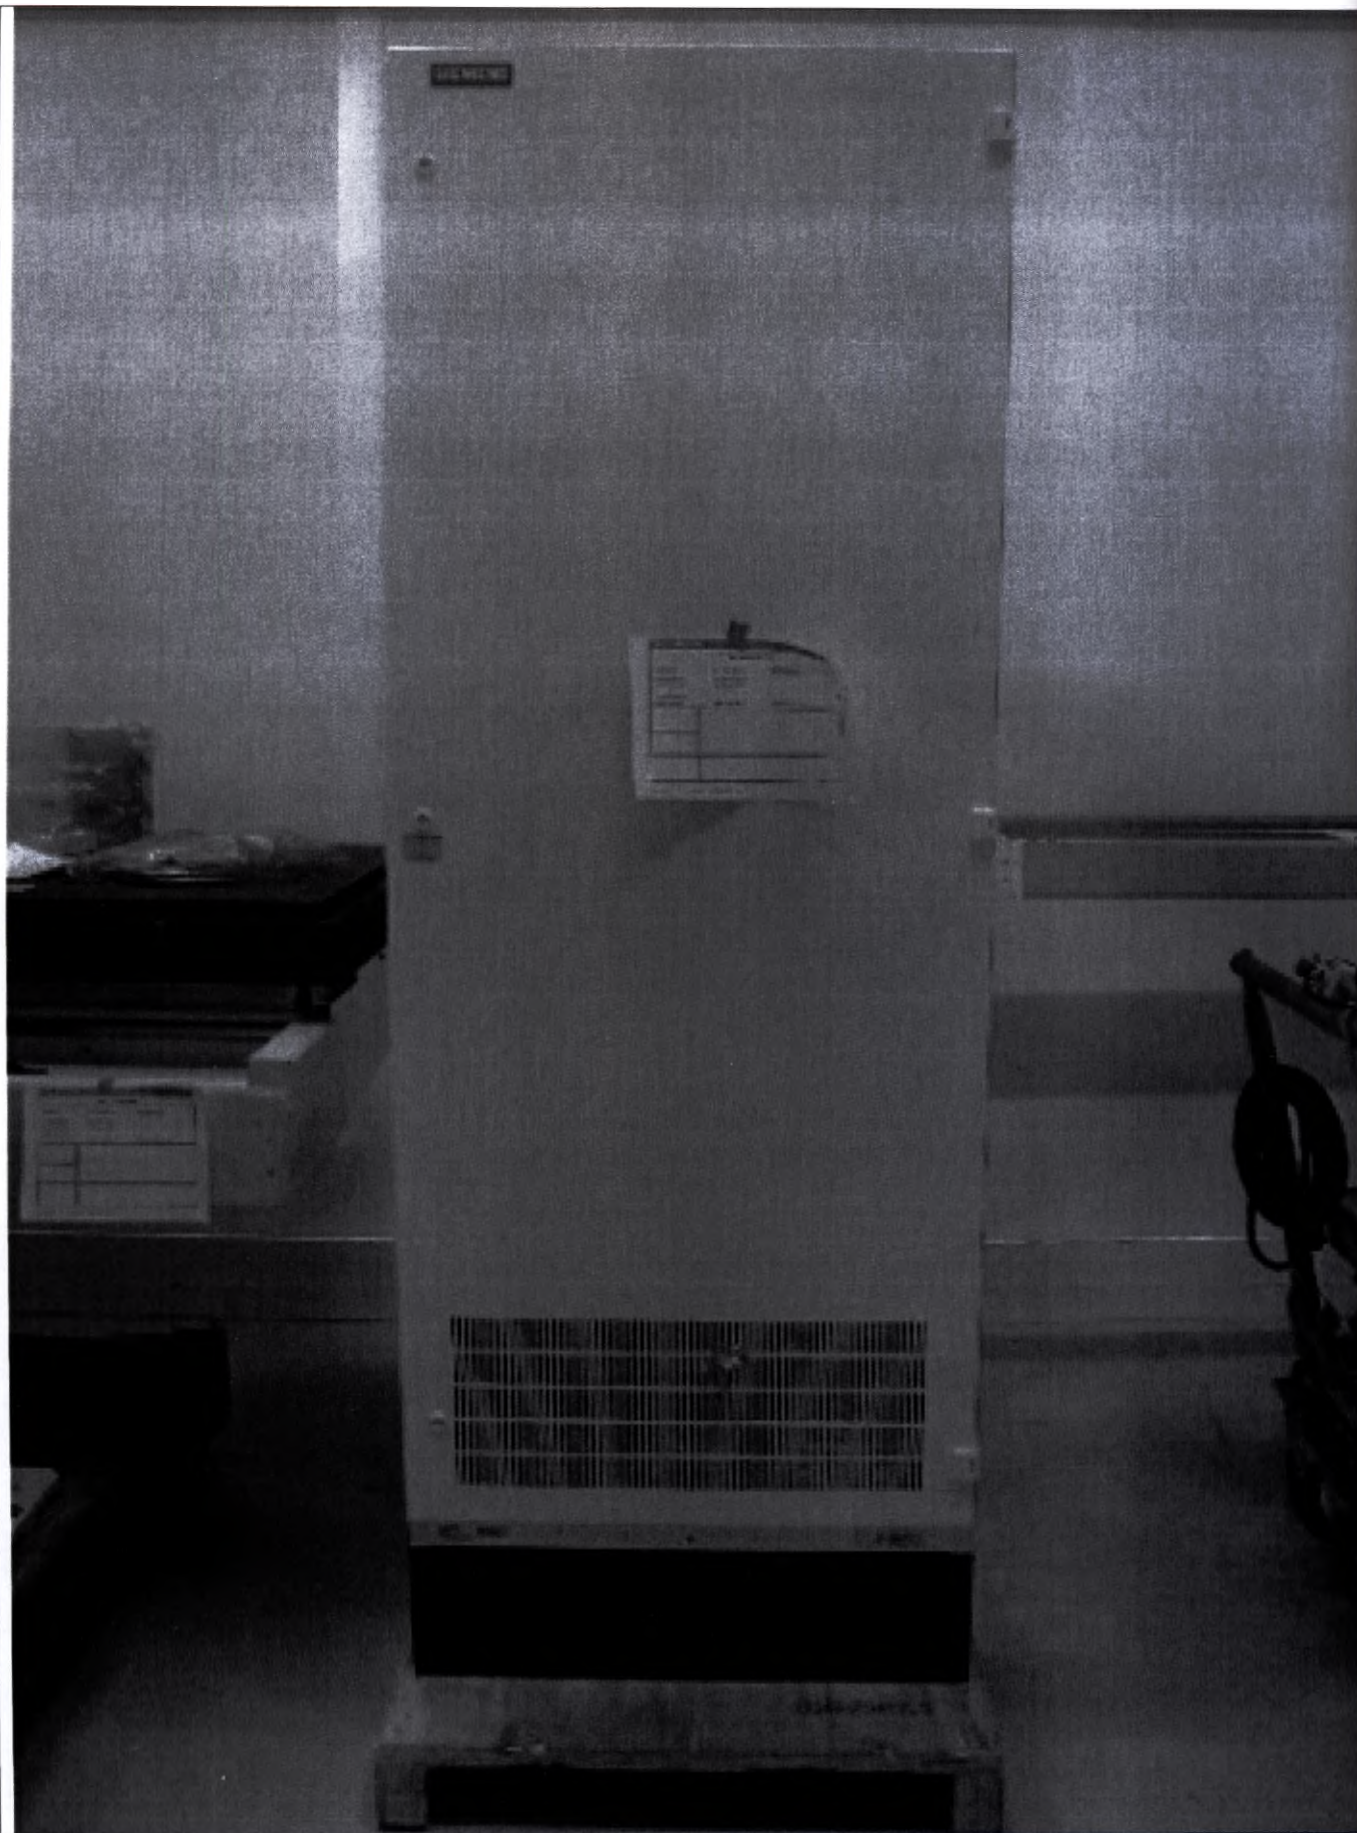


Генератор рентгеновского излучения, варианты исполнения: POLYDOROS F65, POLYDOROS F80.



4. Система коллиматора: коллиматор многолепестковый; центратор оптический.




Система коллиматора: коллиматор многолепестковый; центратор оптический.

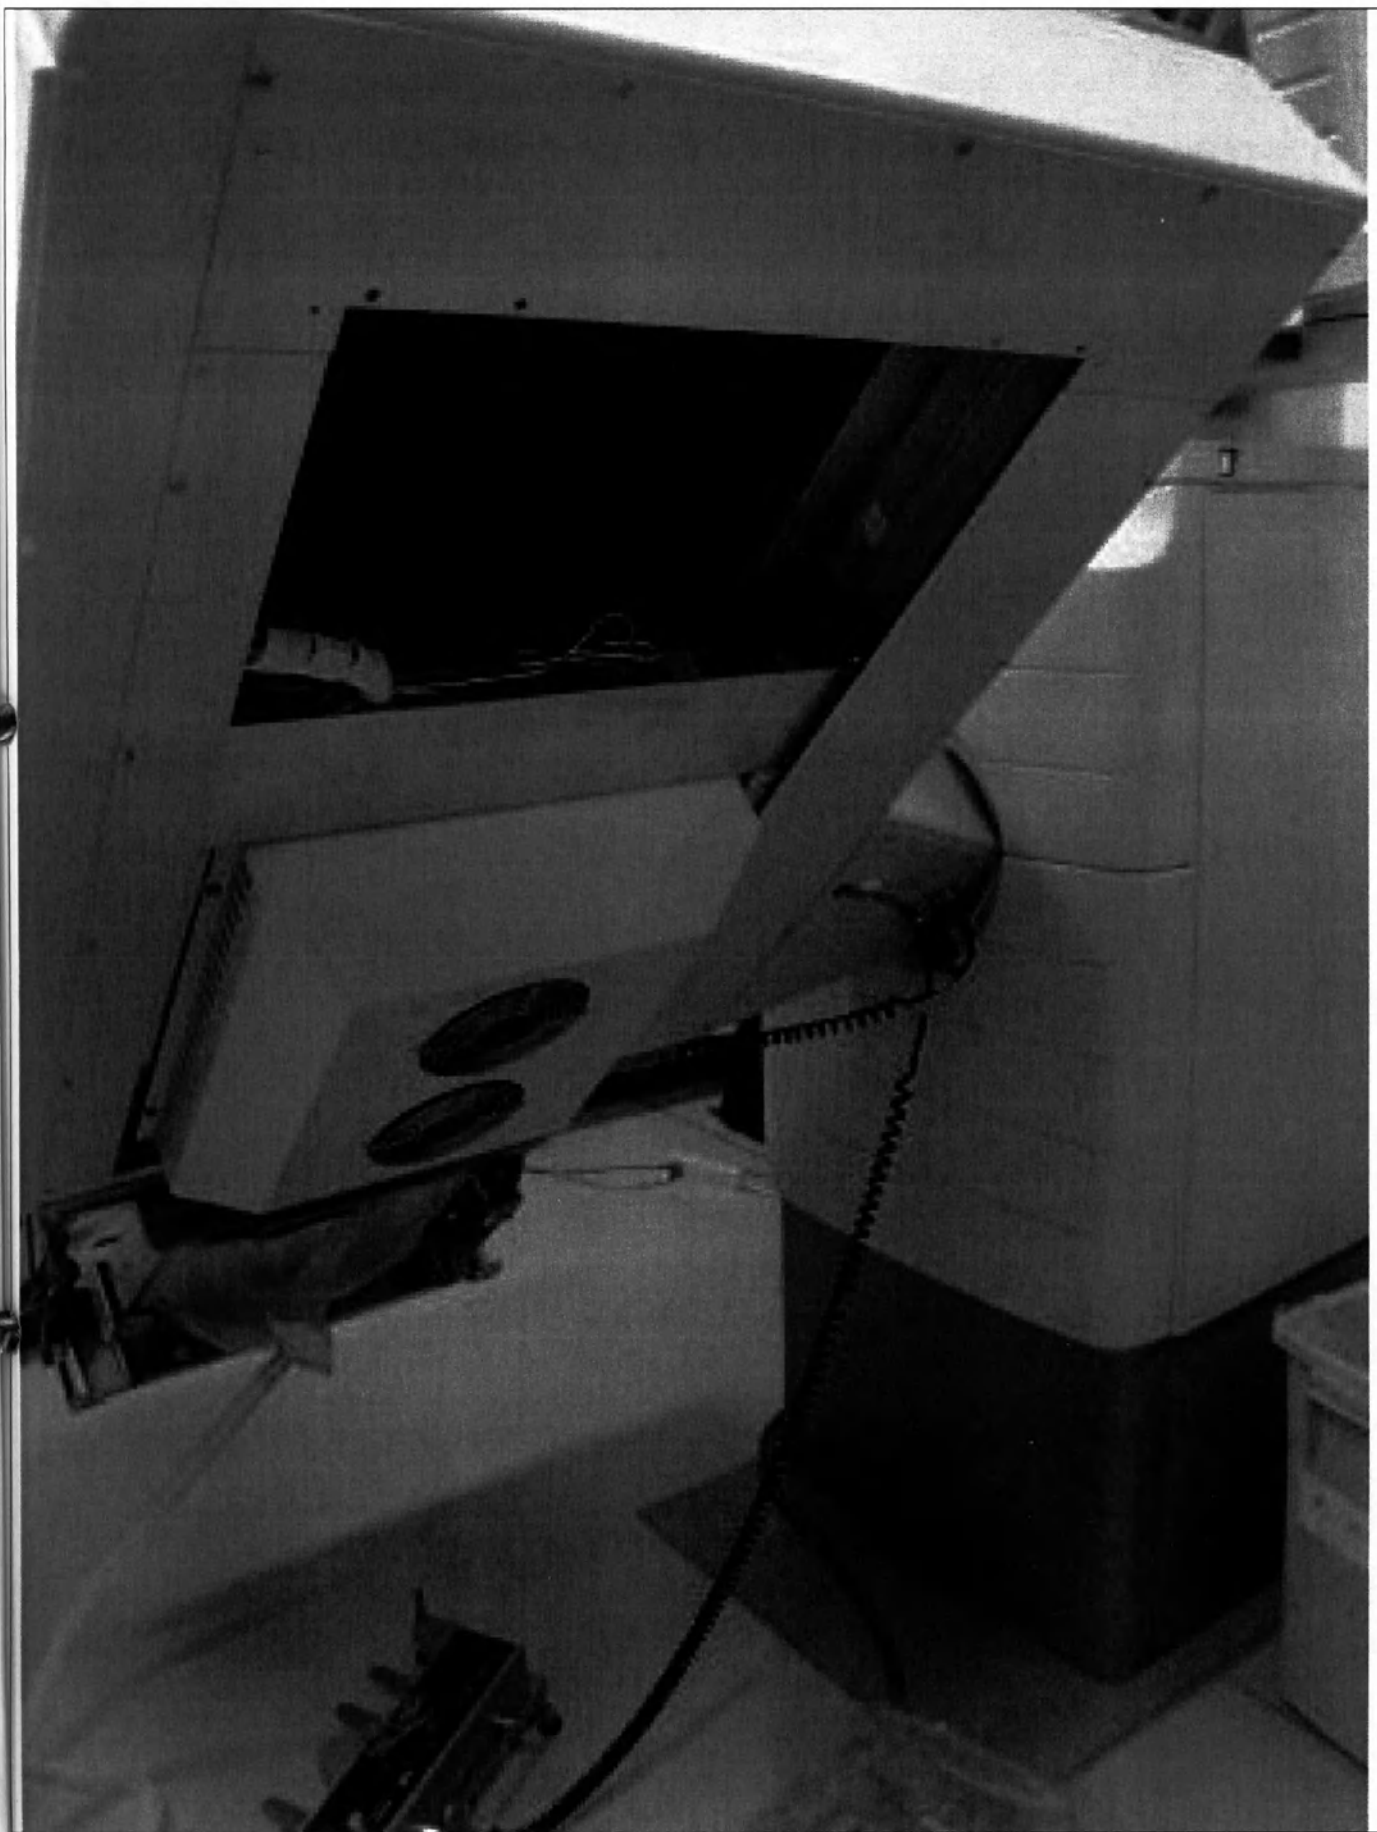


5. Детектор плоский



6.1 Система формирования и обработки цифровых изображений FLUOROSPOT Compact в составе: компьютер; монитор контрольного изображения в пультовой, стандартный или повышенной яркости; CD/DVD-дисковод; клавиатура; мышь; программное обеспечение.

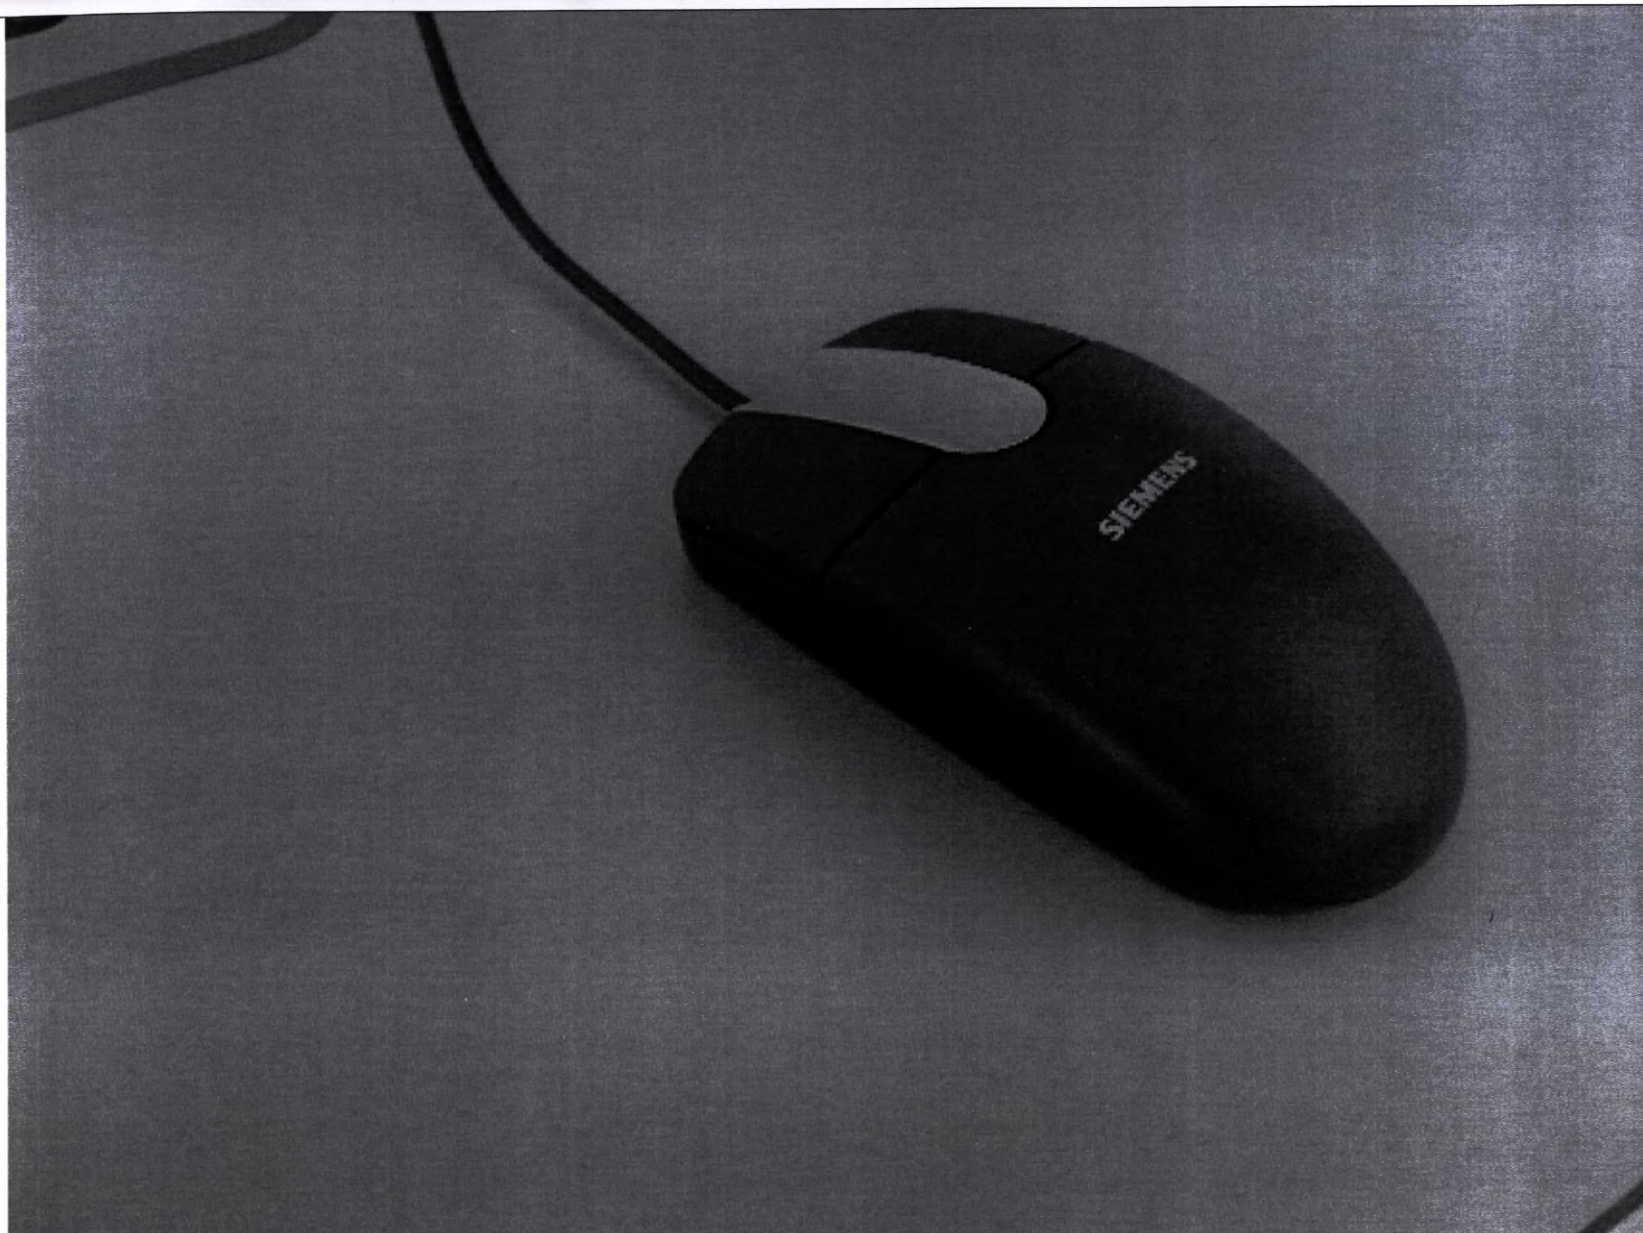


6.2 Система формирования и обработки цифровых изображений FLUOROSPOT Comraci в составе: компьютер; монитор контрольного изображения в пультовой, стандартный или повышенной яркости; CD/DVD-дисковод; клавиатура; мышь; программное обеспечение.

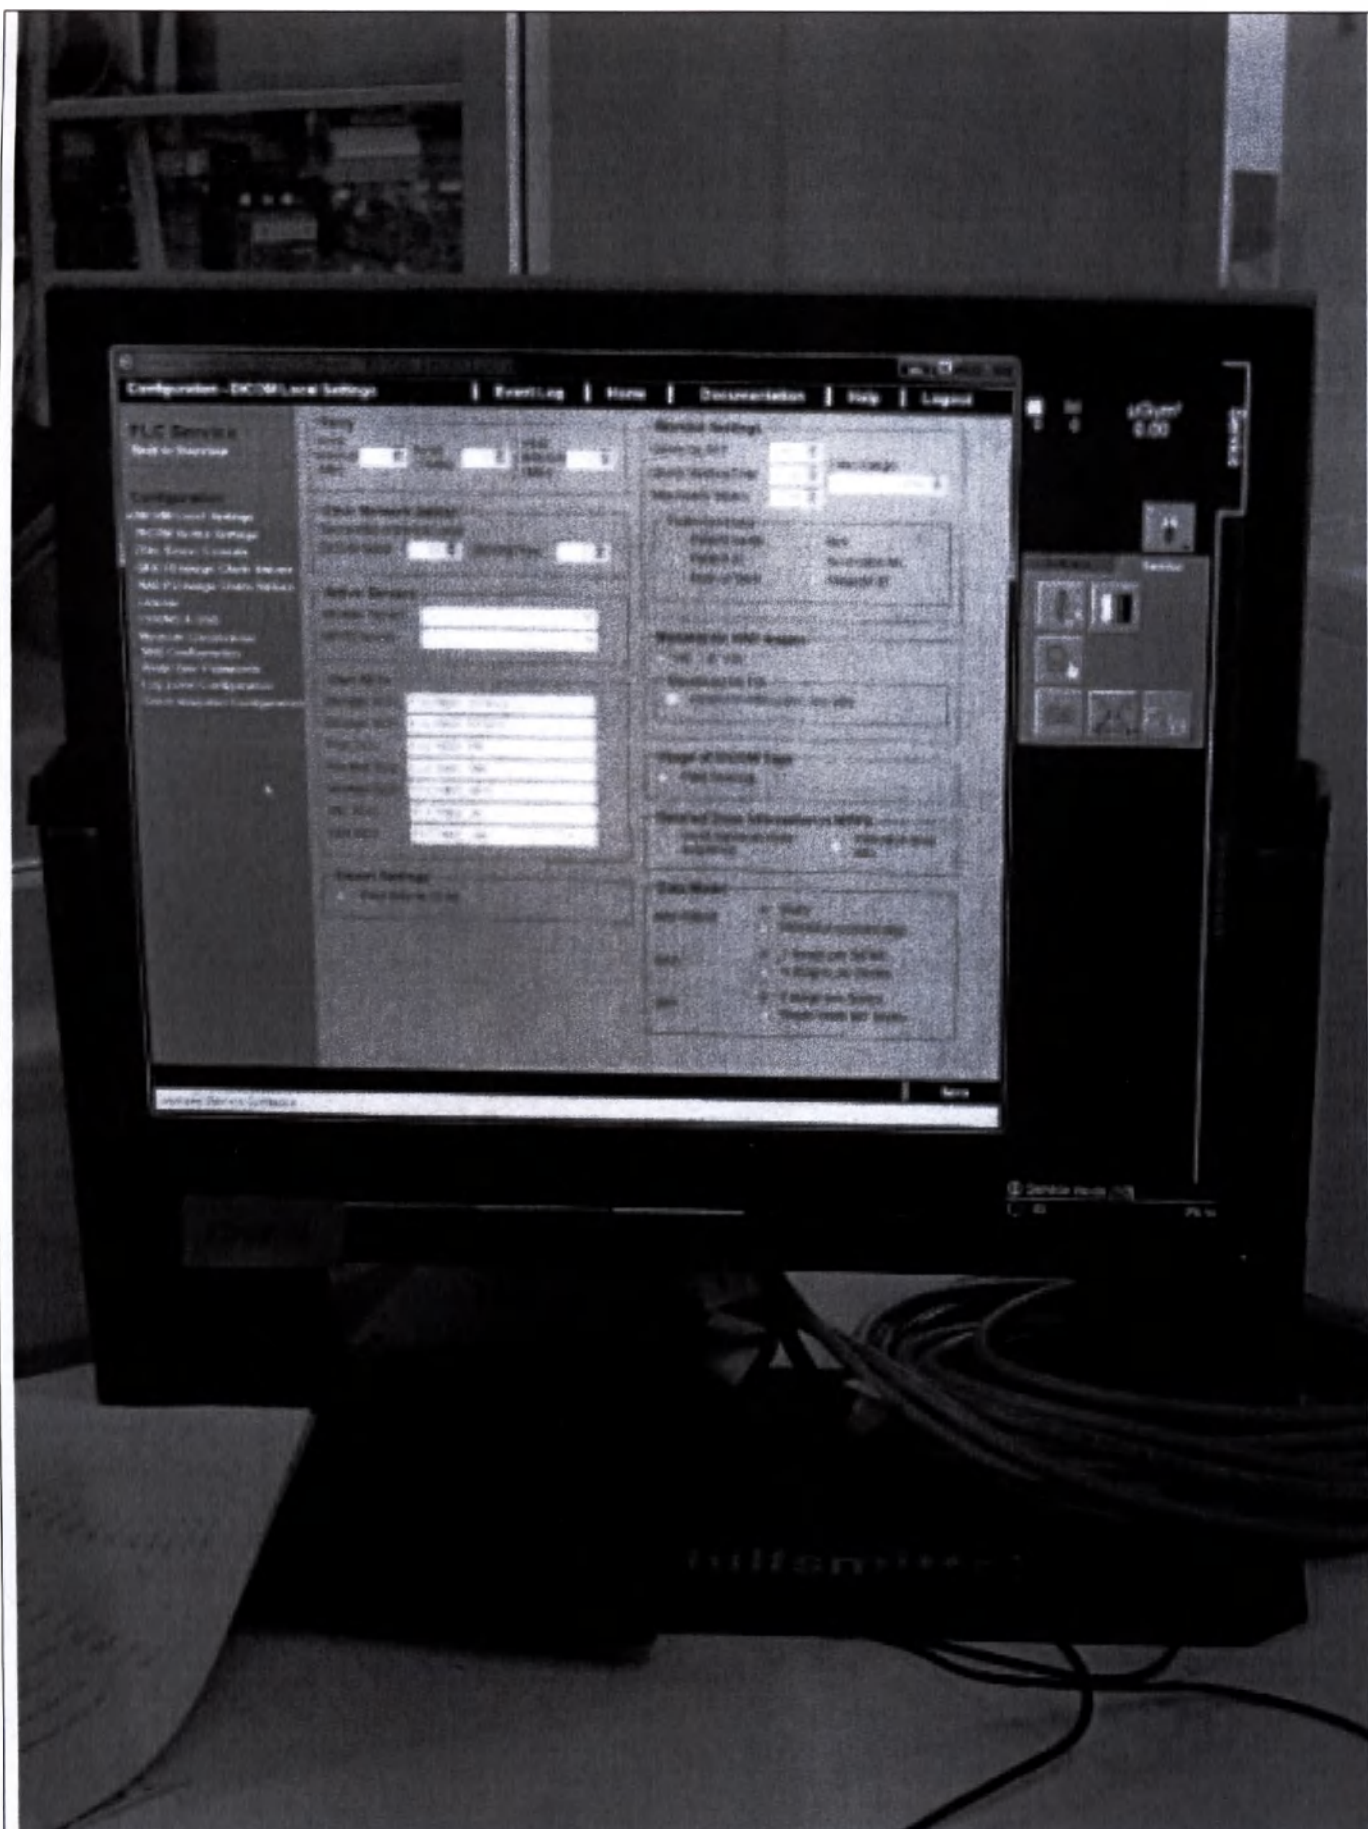

6.3 Система формирования и обработки цифровых изображений FLUOROSPOT Compact в составе: компьютер; монитор контрольного изображения в пультовой, стандартный или повышенной яркости; CD/DVD-дисковод; клавиатура; мышь; программное обеспечение..




6.4 Система формирования и обработки цифровых изображений FLUOROSPOT Compact в составе: компьютер; монитор контрольного изображения в пультовой, стандартный или повышенной яркости; CD/DVD-дисковод; клавиатура; мышь; программное обеспечение.

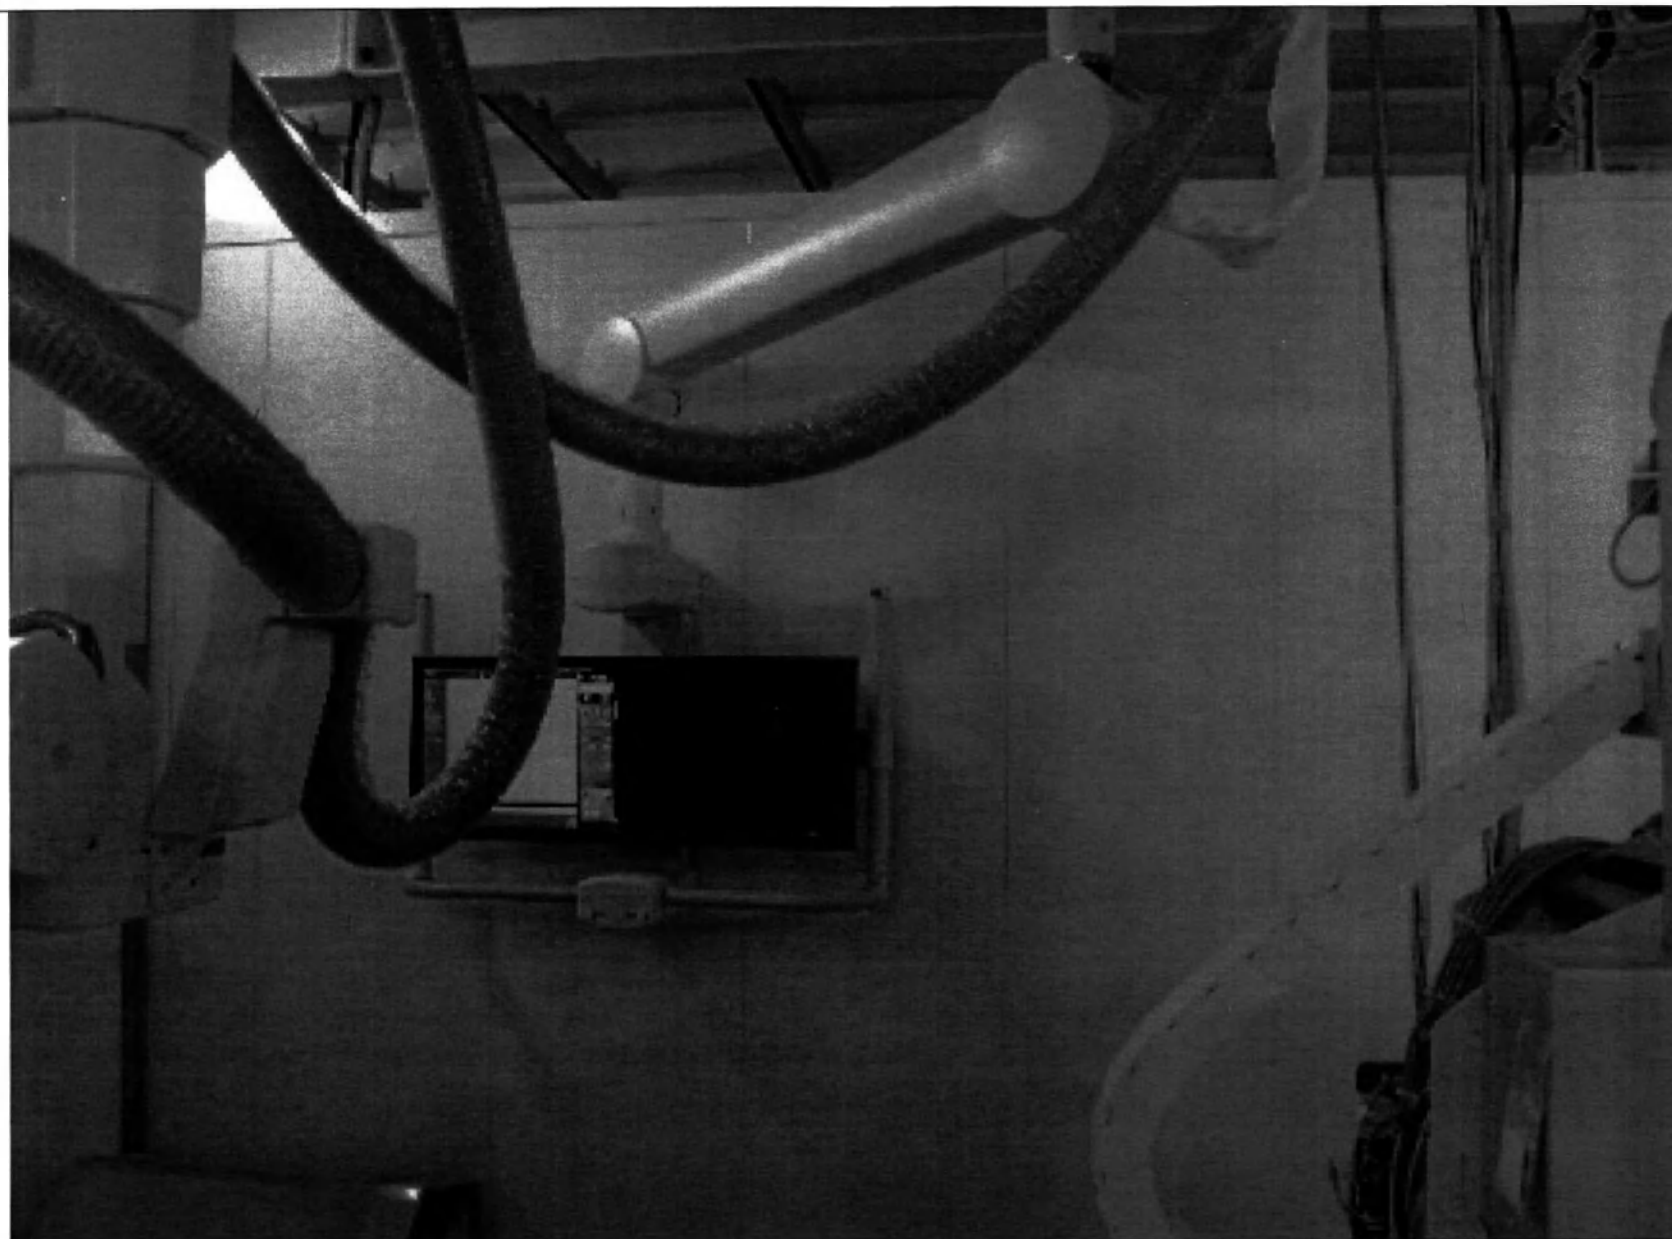

6.5 Система формирования и обработки цифровых изображений FLUOROSPOT Compact в составе: компьютер; монитор контрольного изображения в пультовой, стандартный или повышенной яркости; CD/DVD-дисковод; клавиатура; мышь; программное обеспечение.



7. Мониторы прямого изображения в кабинете для обследований, варианты исполнения: - стандартные; - повышенной яркости.

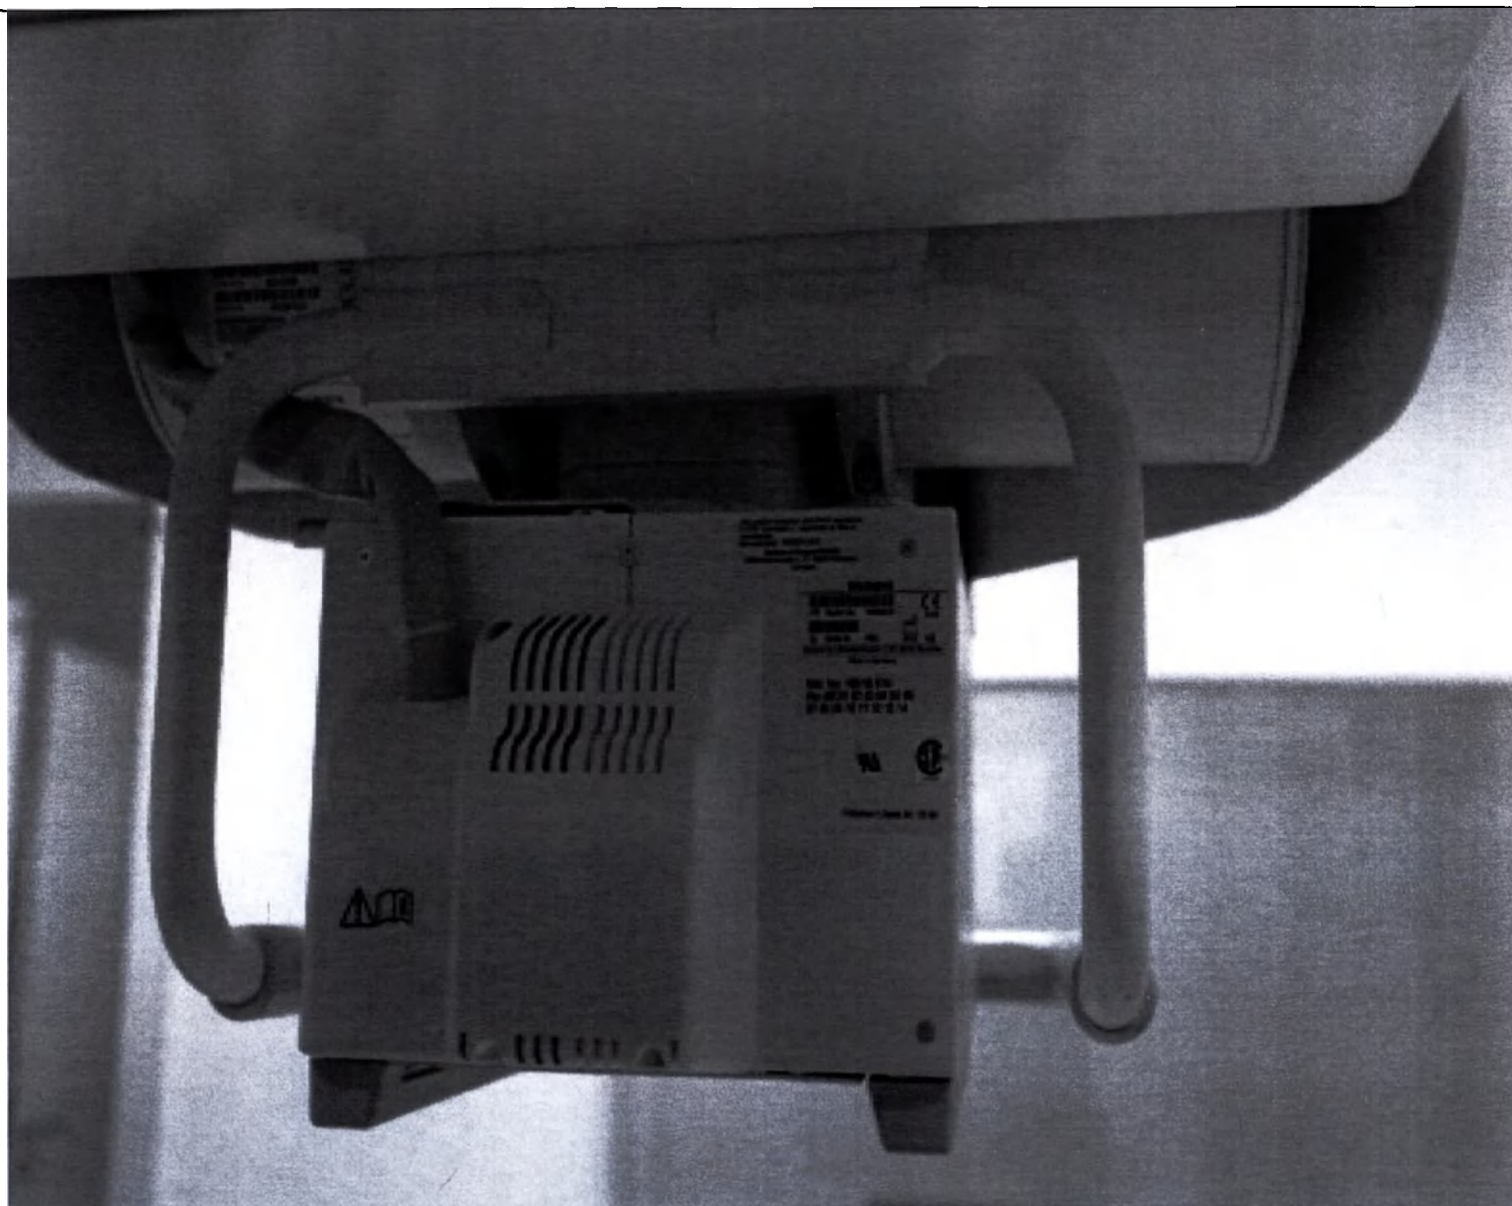

8. Блок измерения суммарной поверхностной дозы CAREMAX.

Uroskop Omnia Max


Руководство пользователя – VF11 и более поздние версии

siemens-healthineers.com

SIEMENS
Healthineers 

Документация пользователя на русском языке


II. Принадлежности

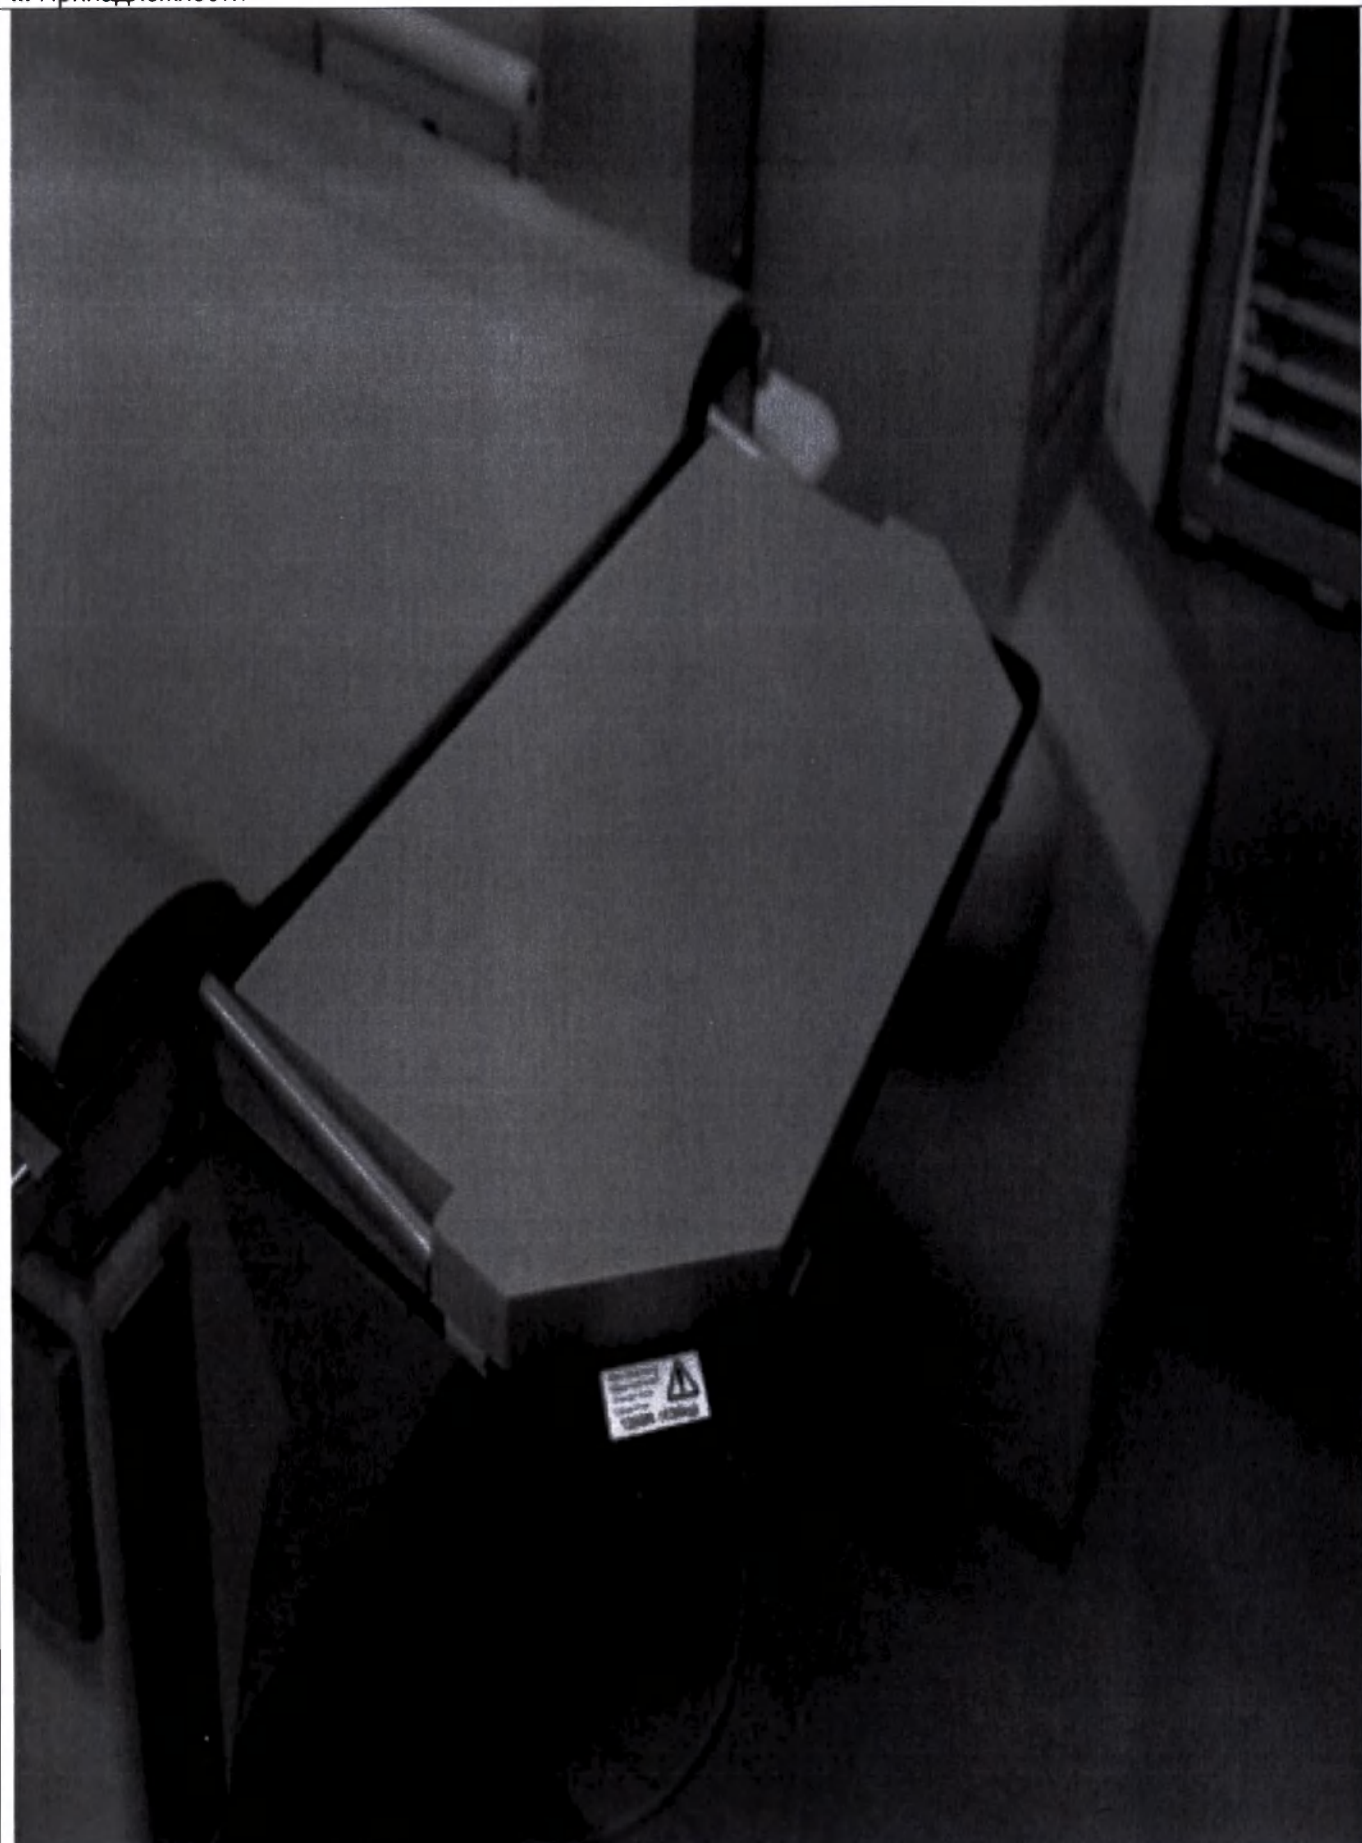

1. Удлинение деки стола 30 см.



2. Опоры для голени CoxaFix, пристегиваемые.

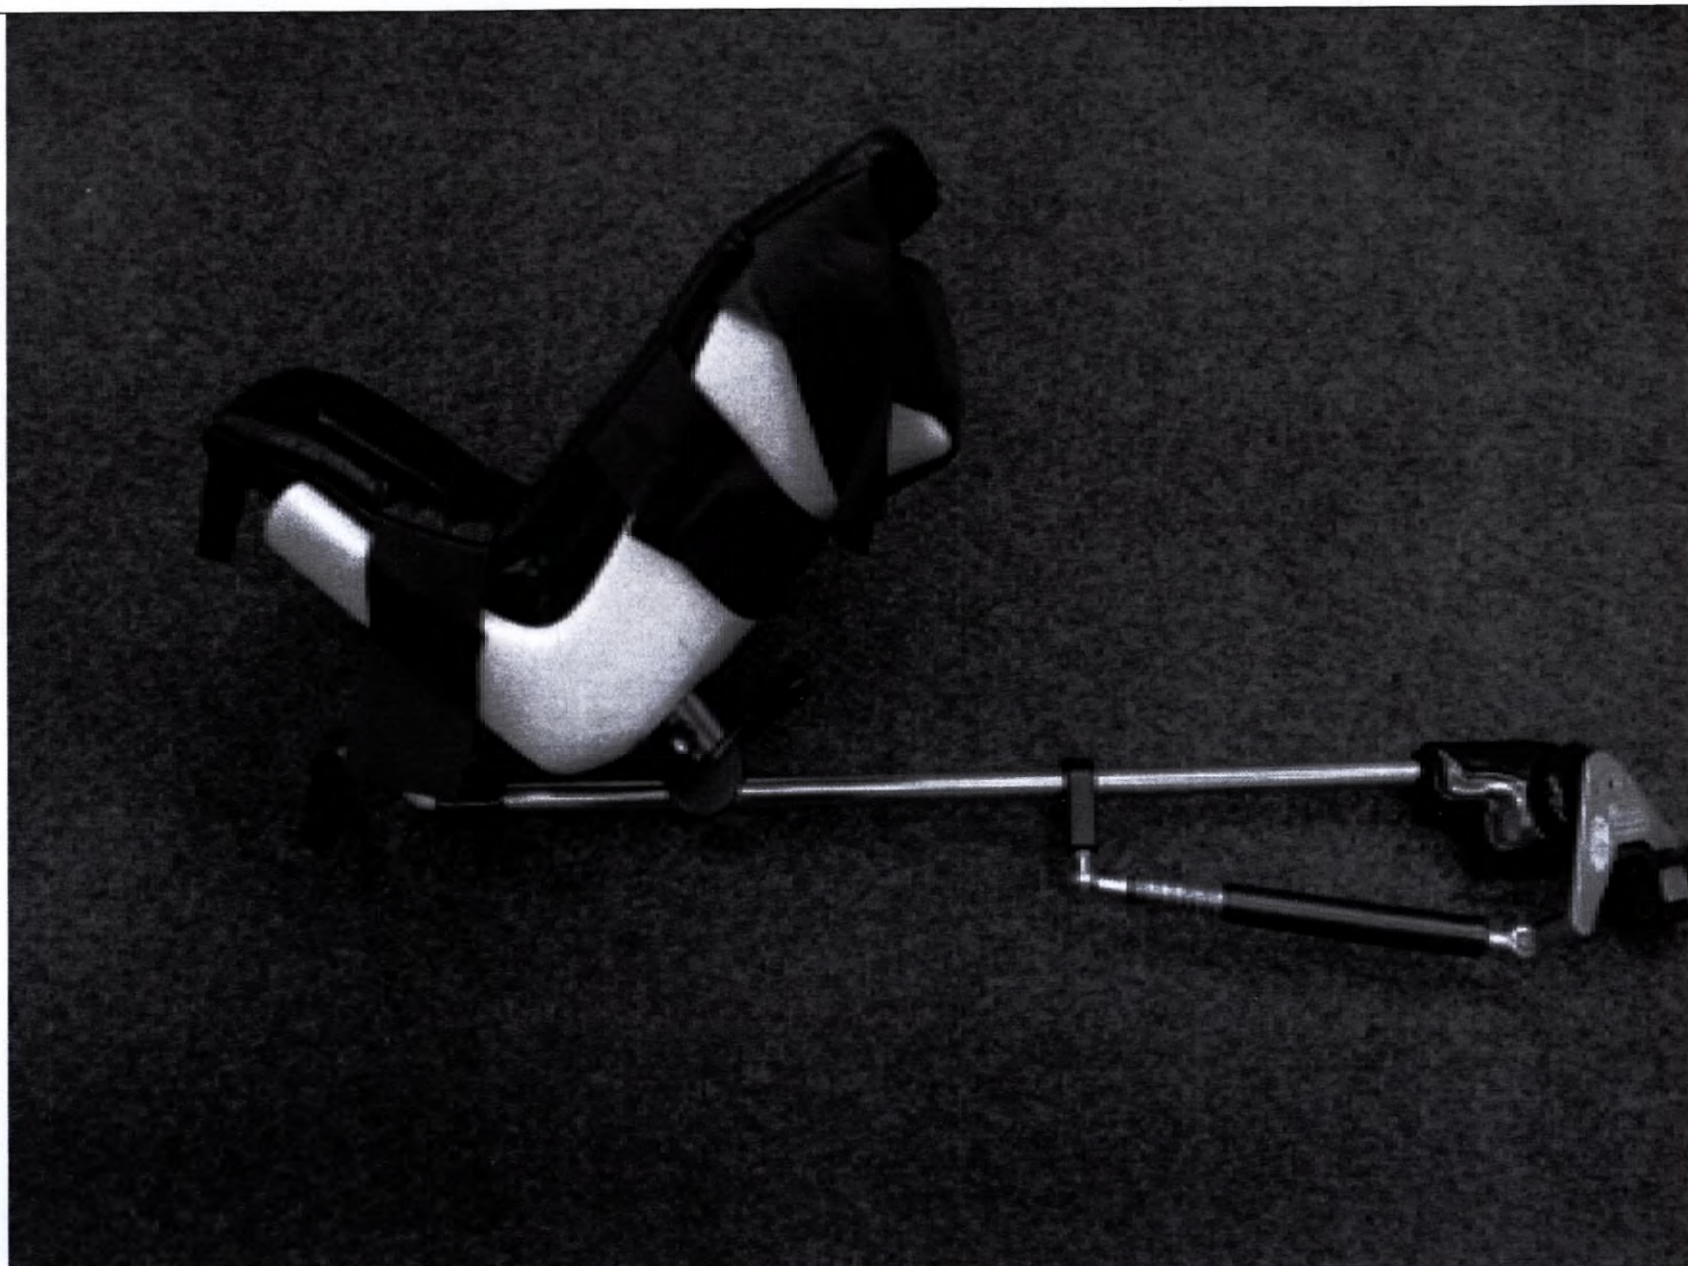

3. Опоры для голени Soxafix, надеваемые.




4. Педиатрические подставки для голеней




5. Поручень




б. Подплечники

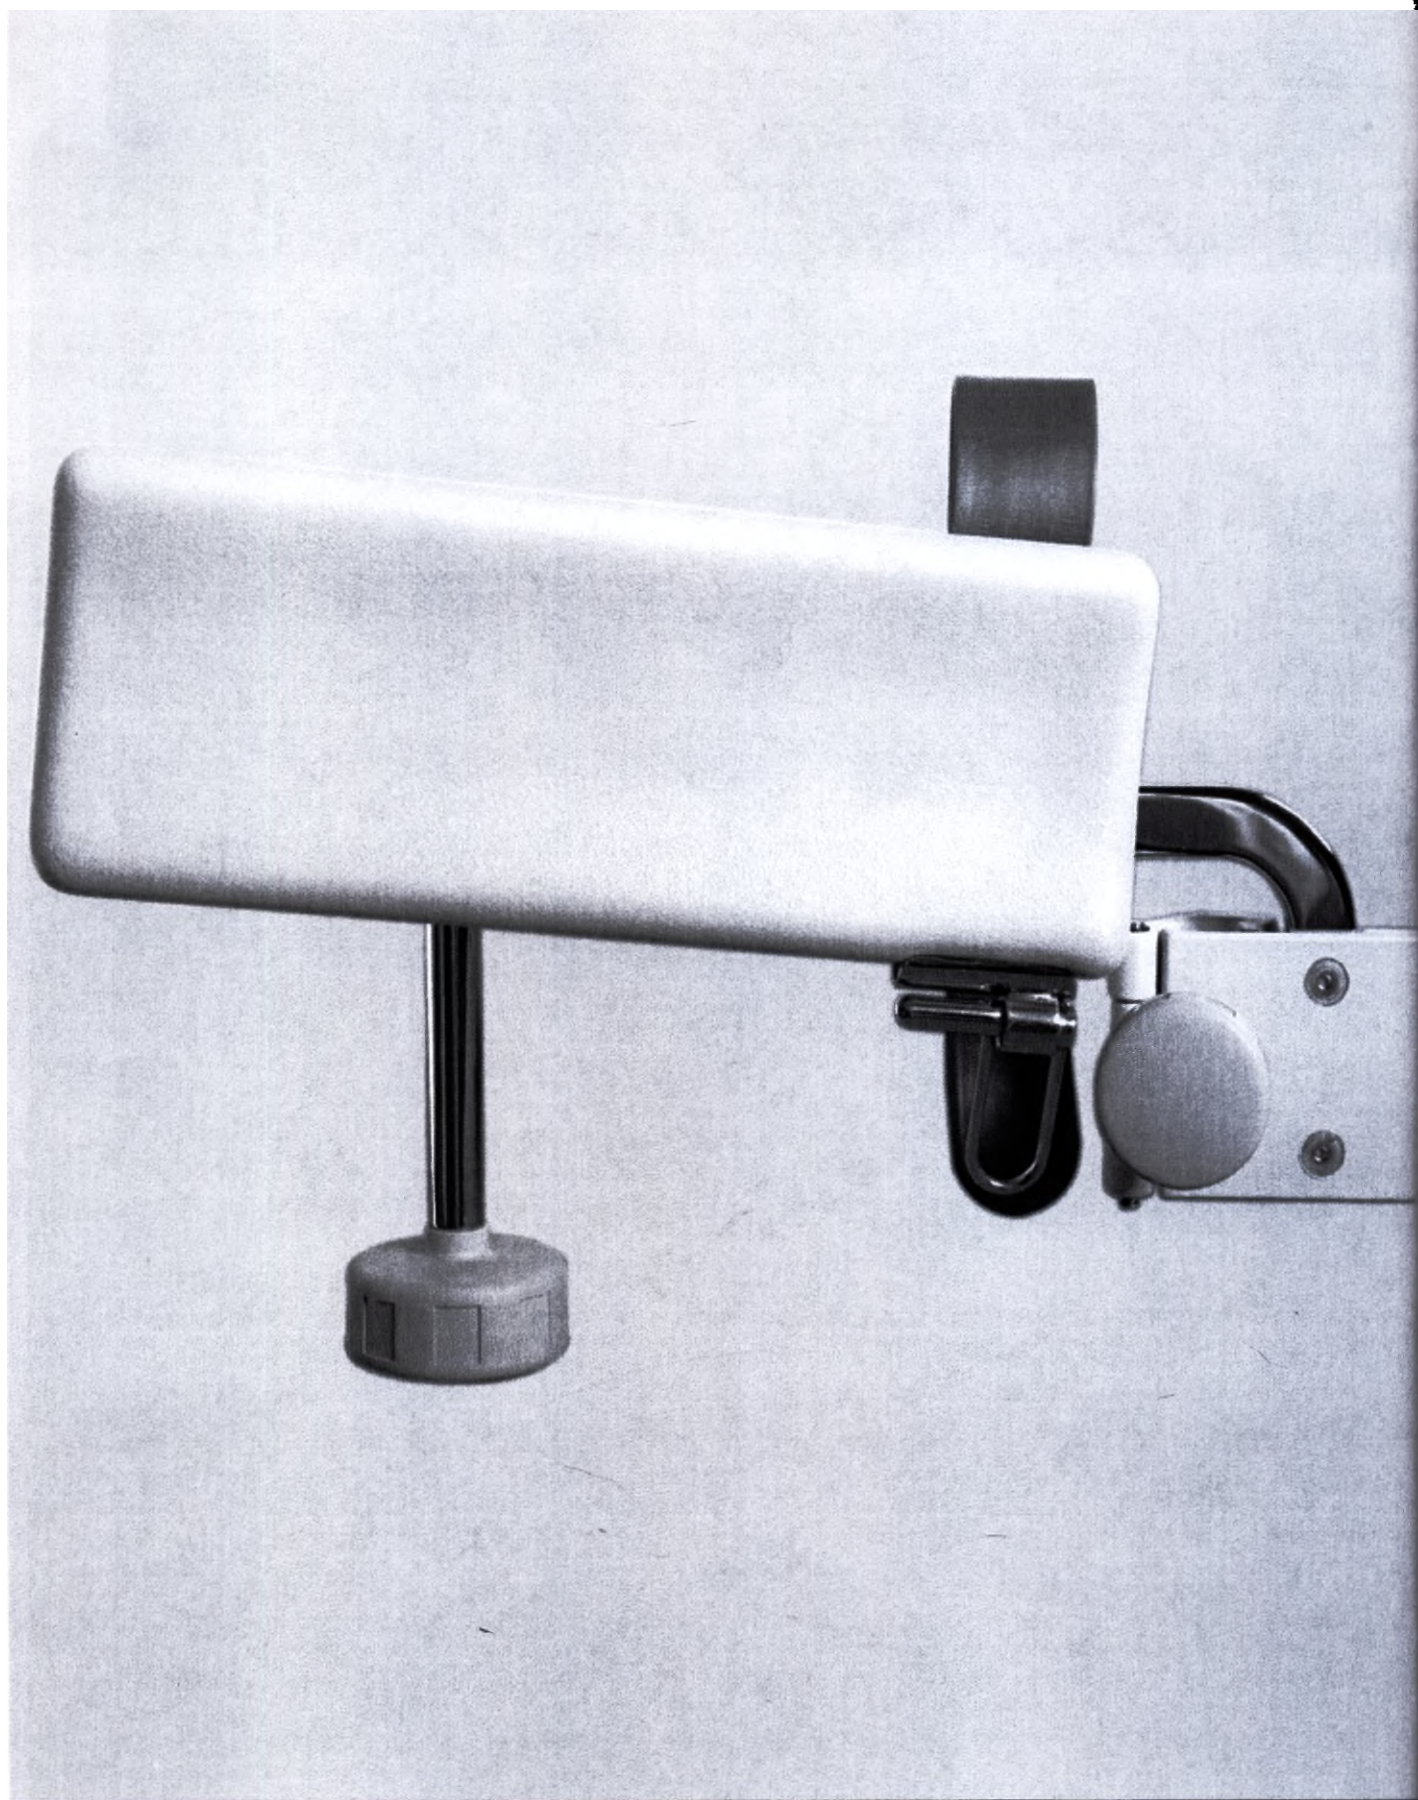


7. Опора для рук пациента

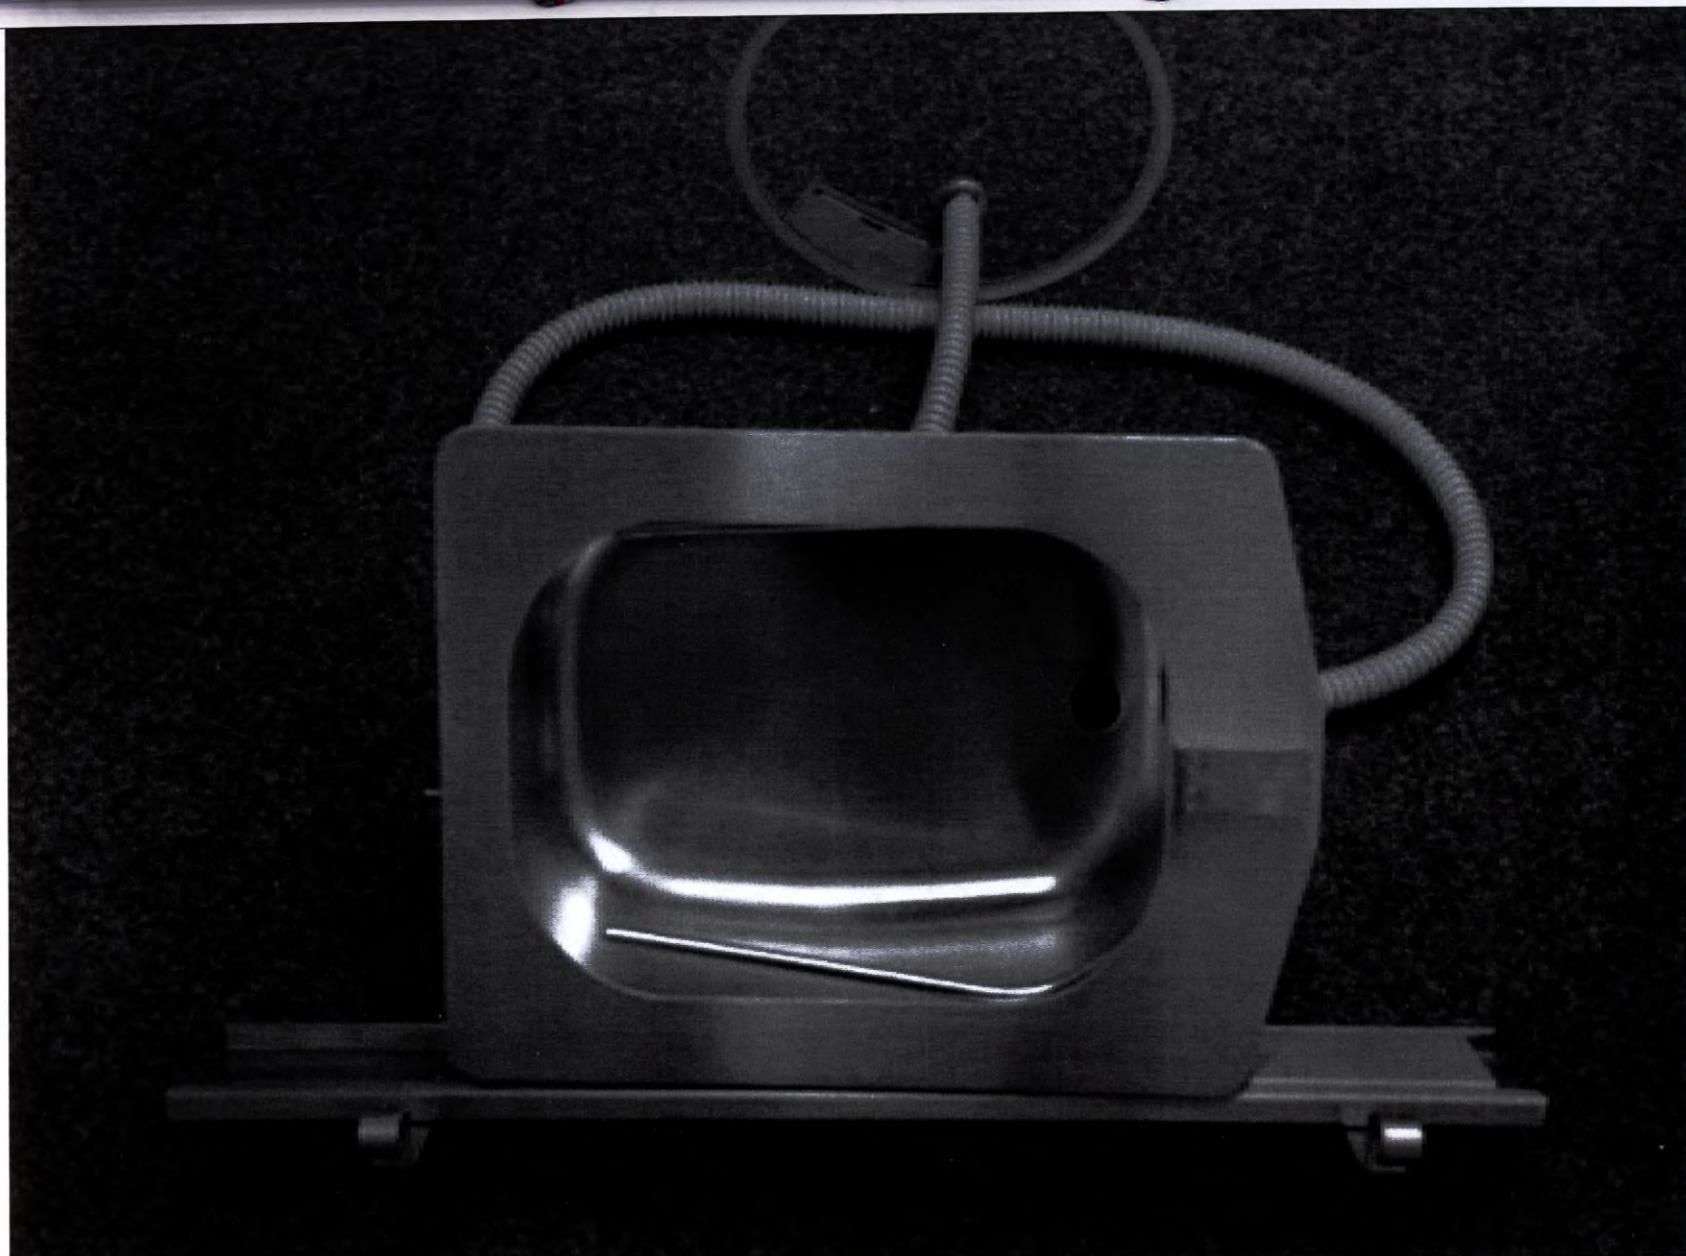


8. Дренажный поддон

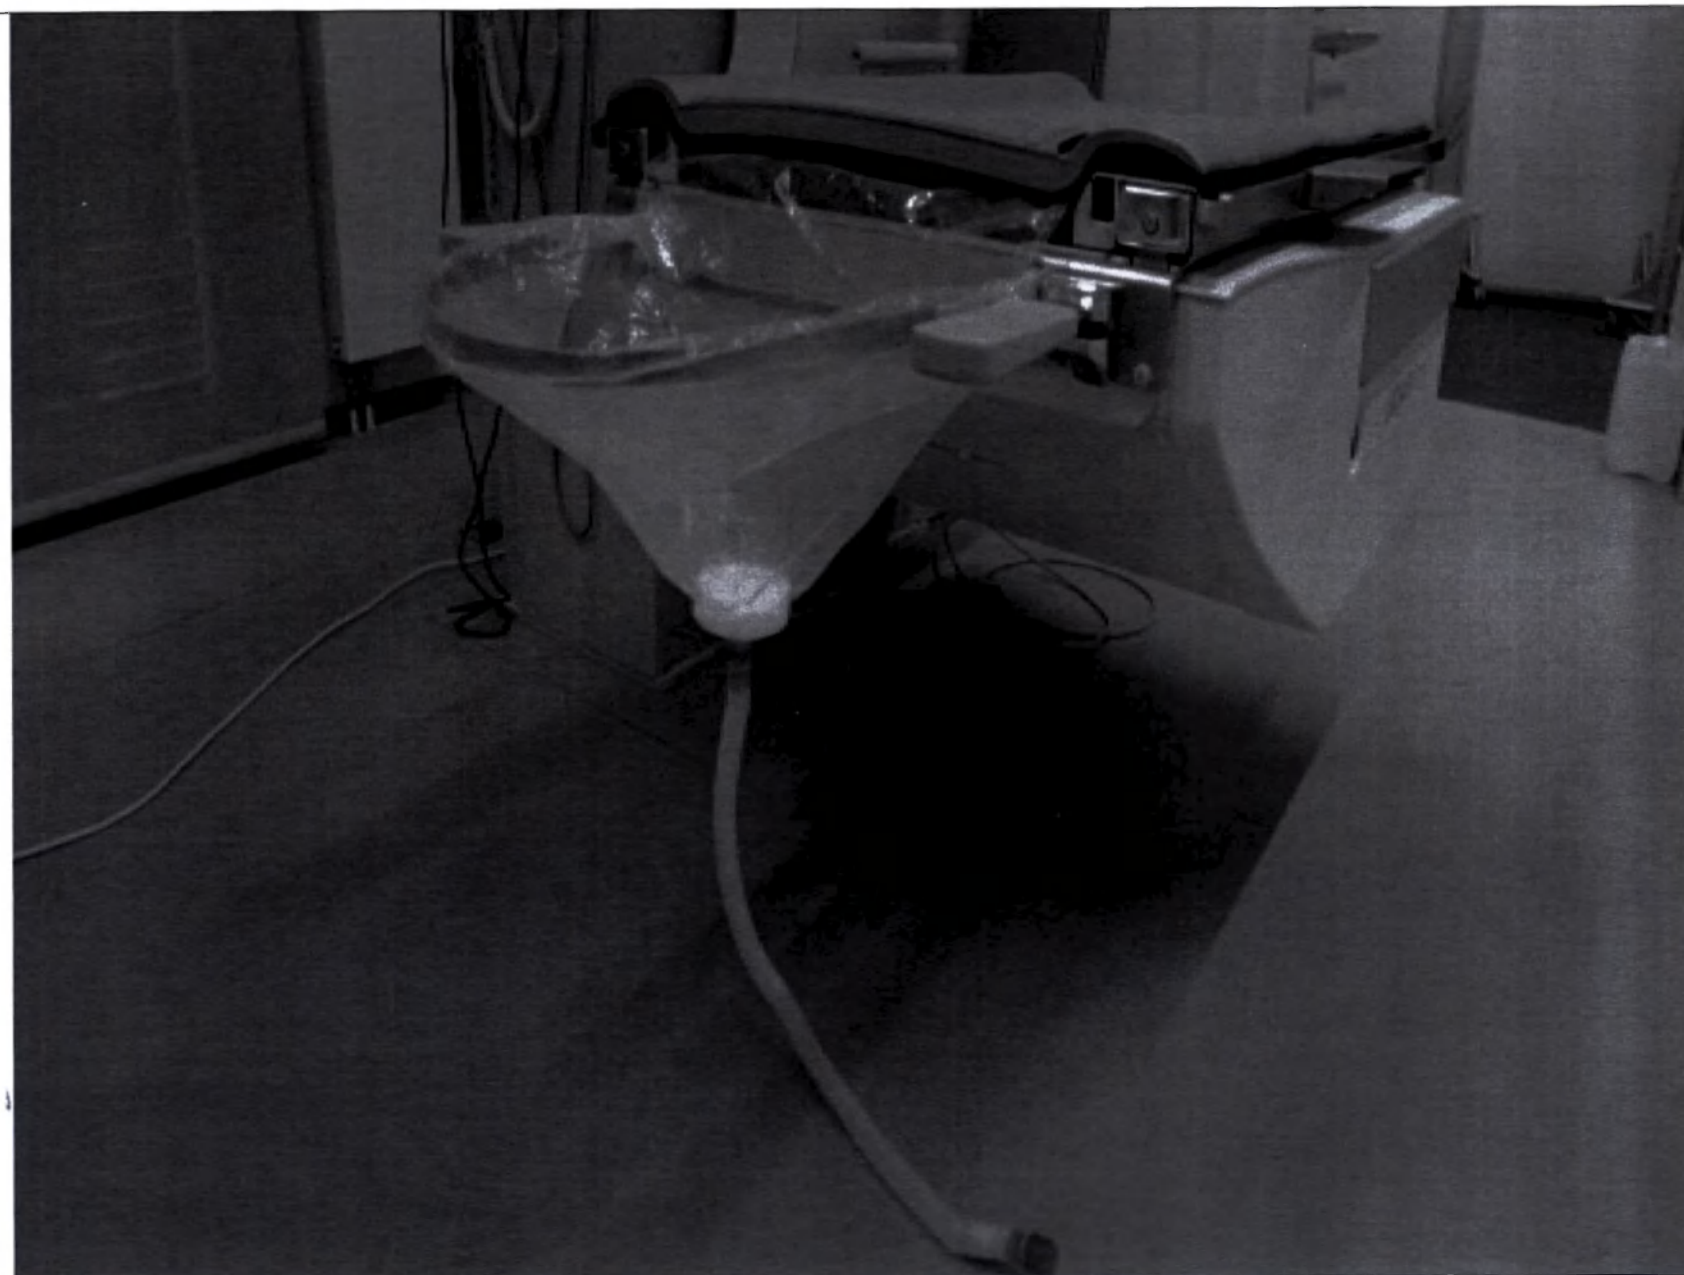


9. Пластмассовый дренажный мешок

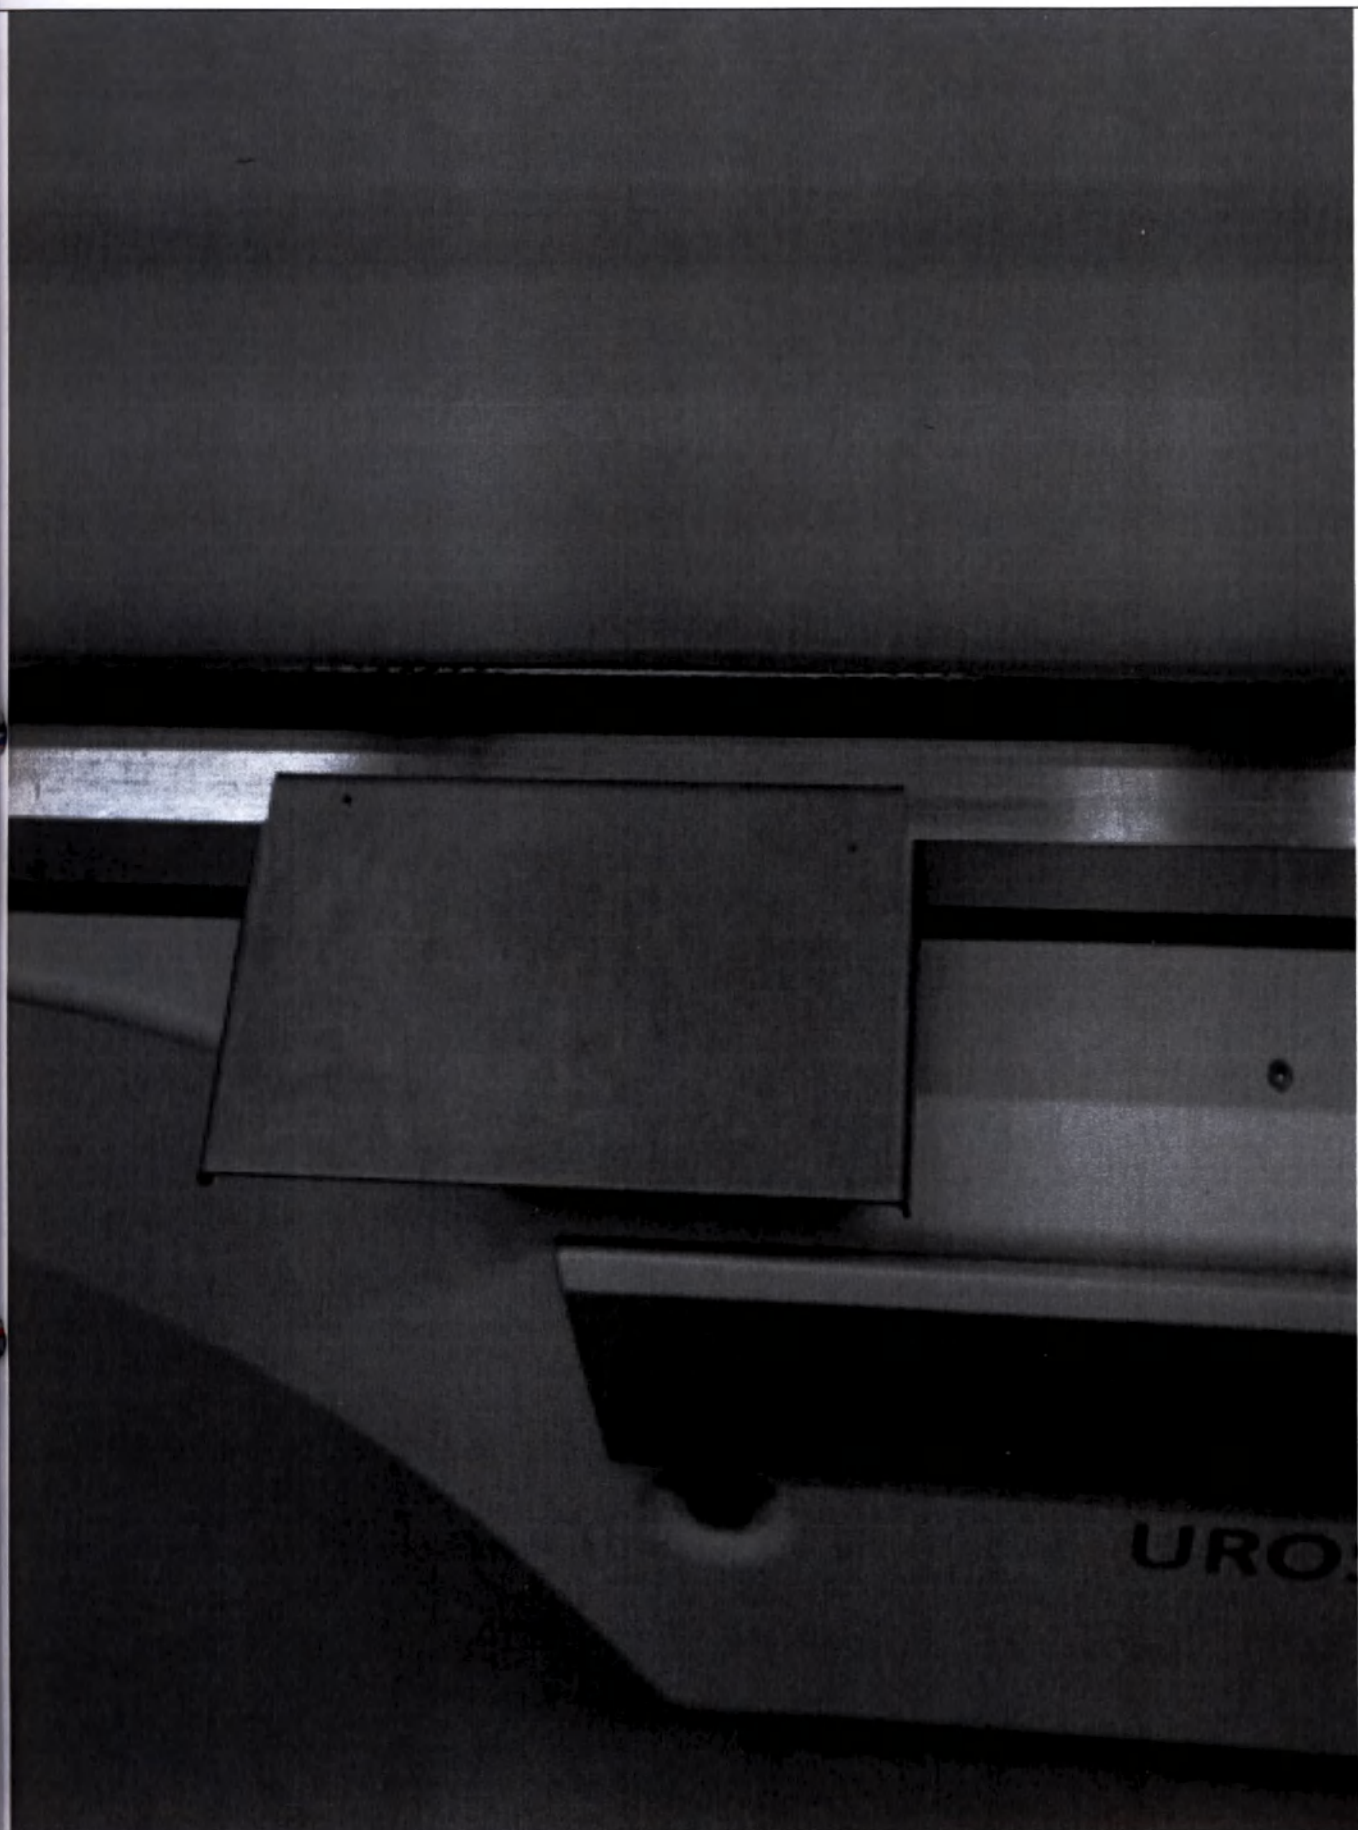


10. Крепеж для пульта дистанционного управления

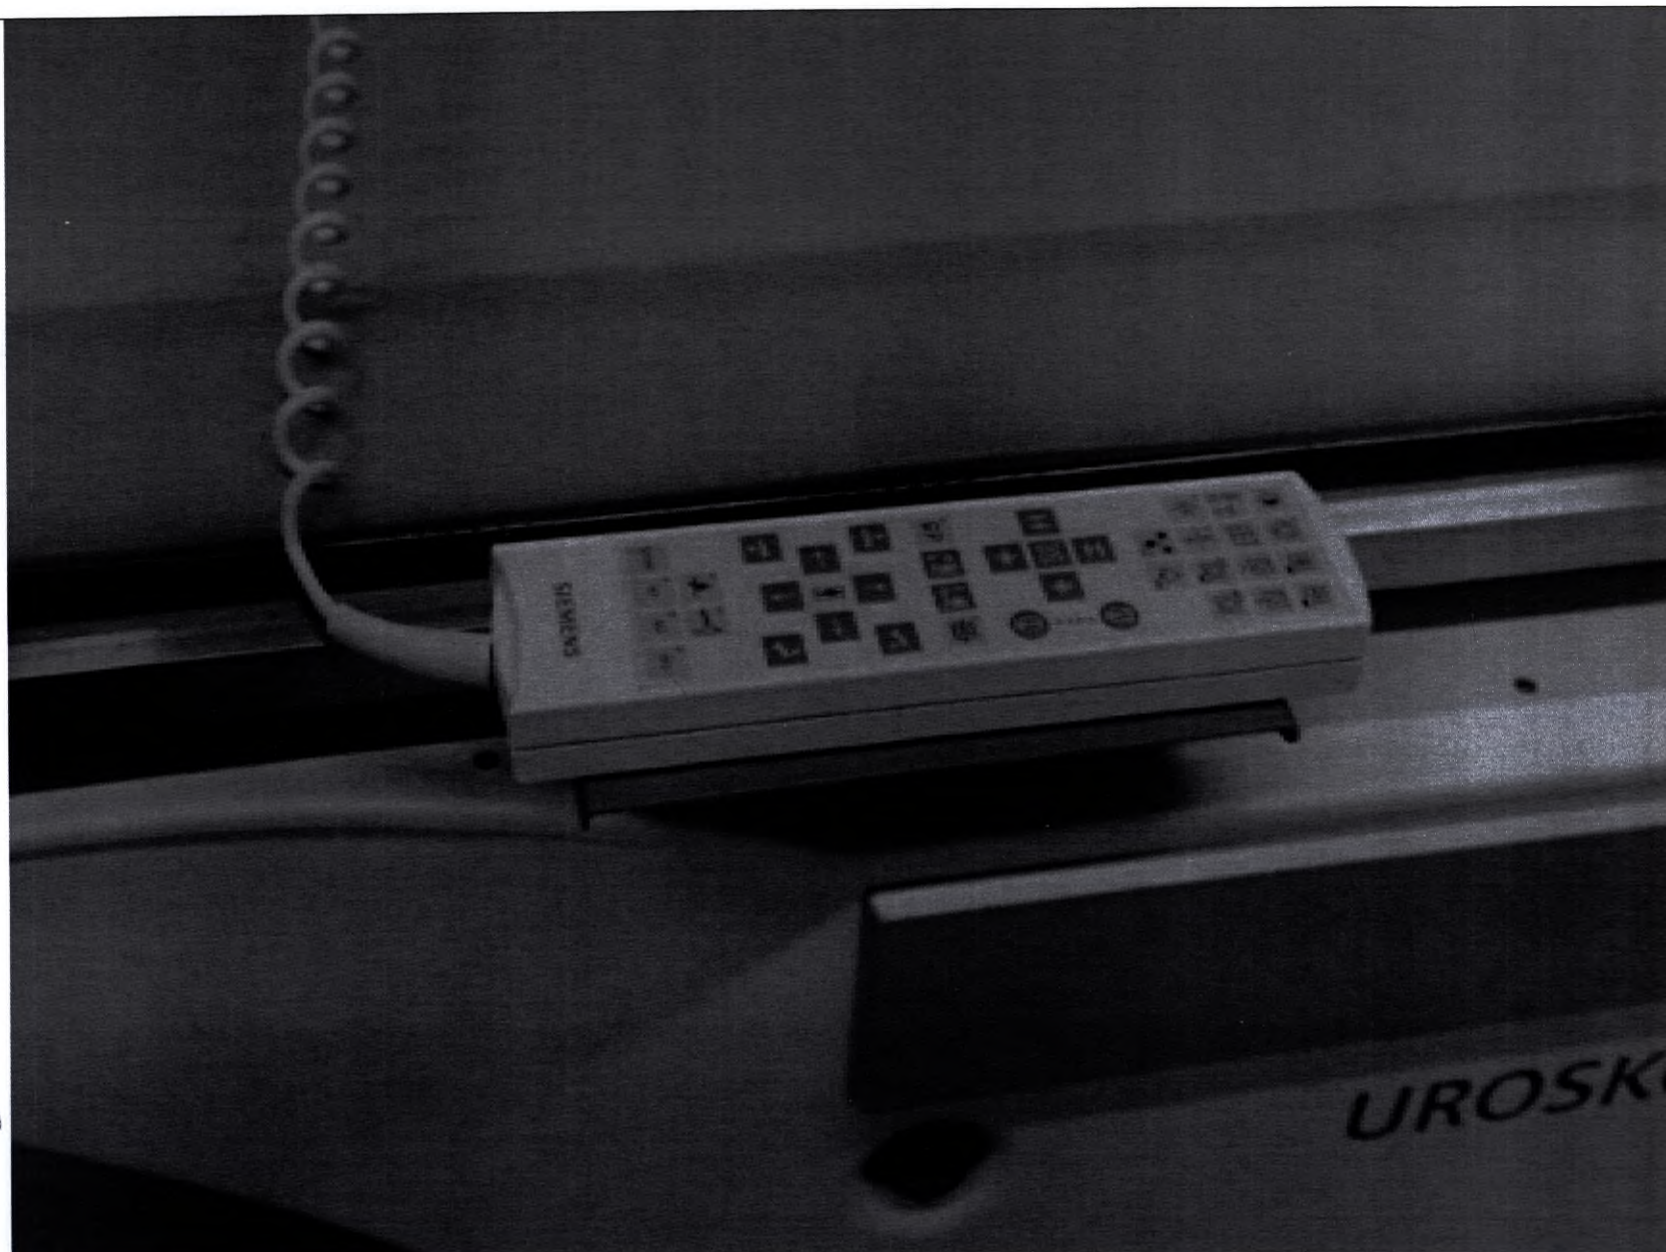


11. Ручной пульт управления

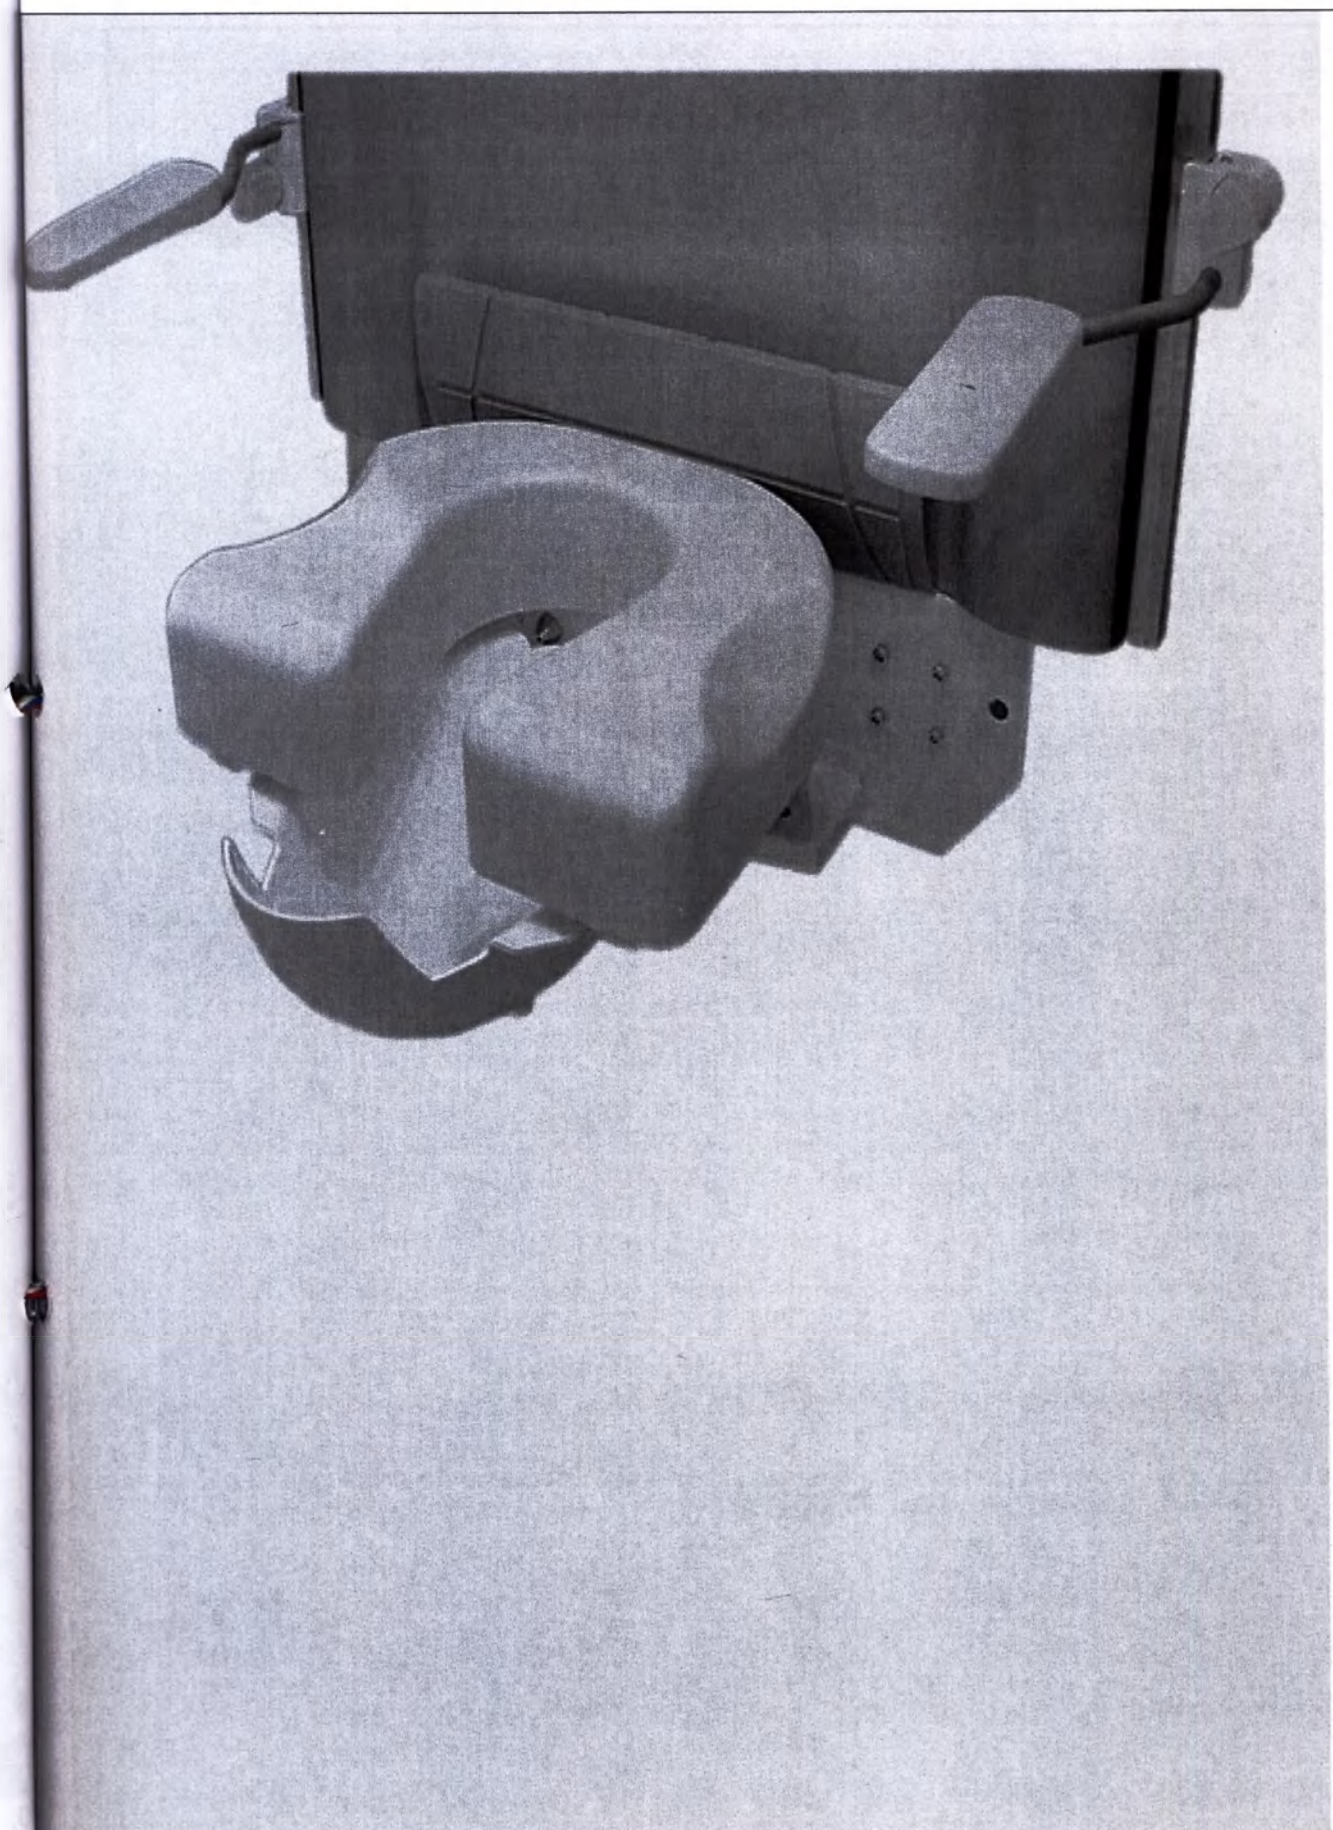


Мочеприемник

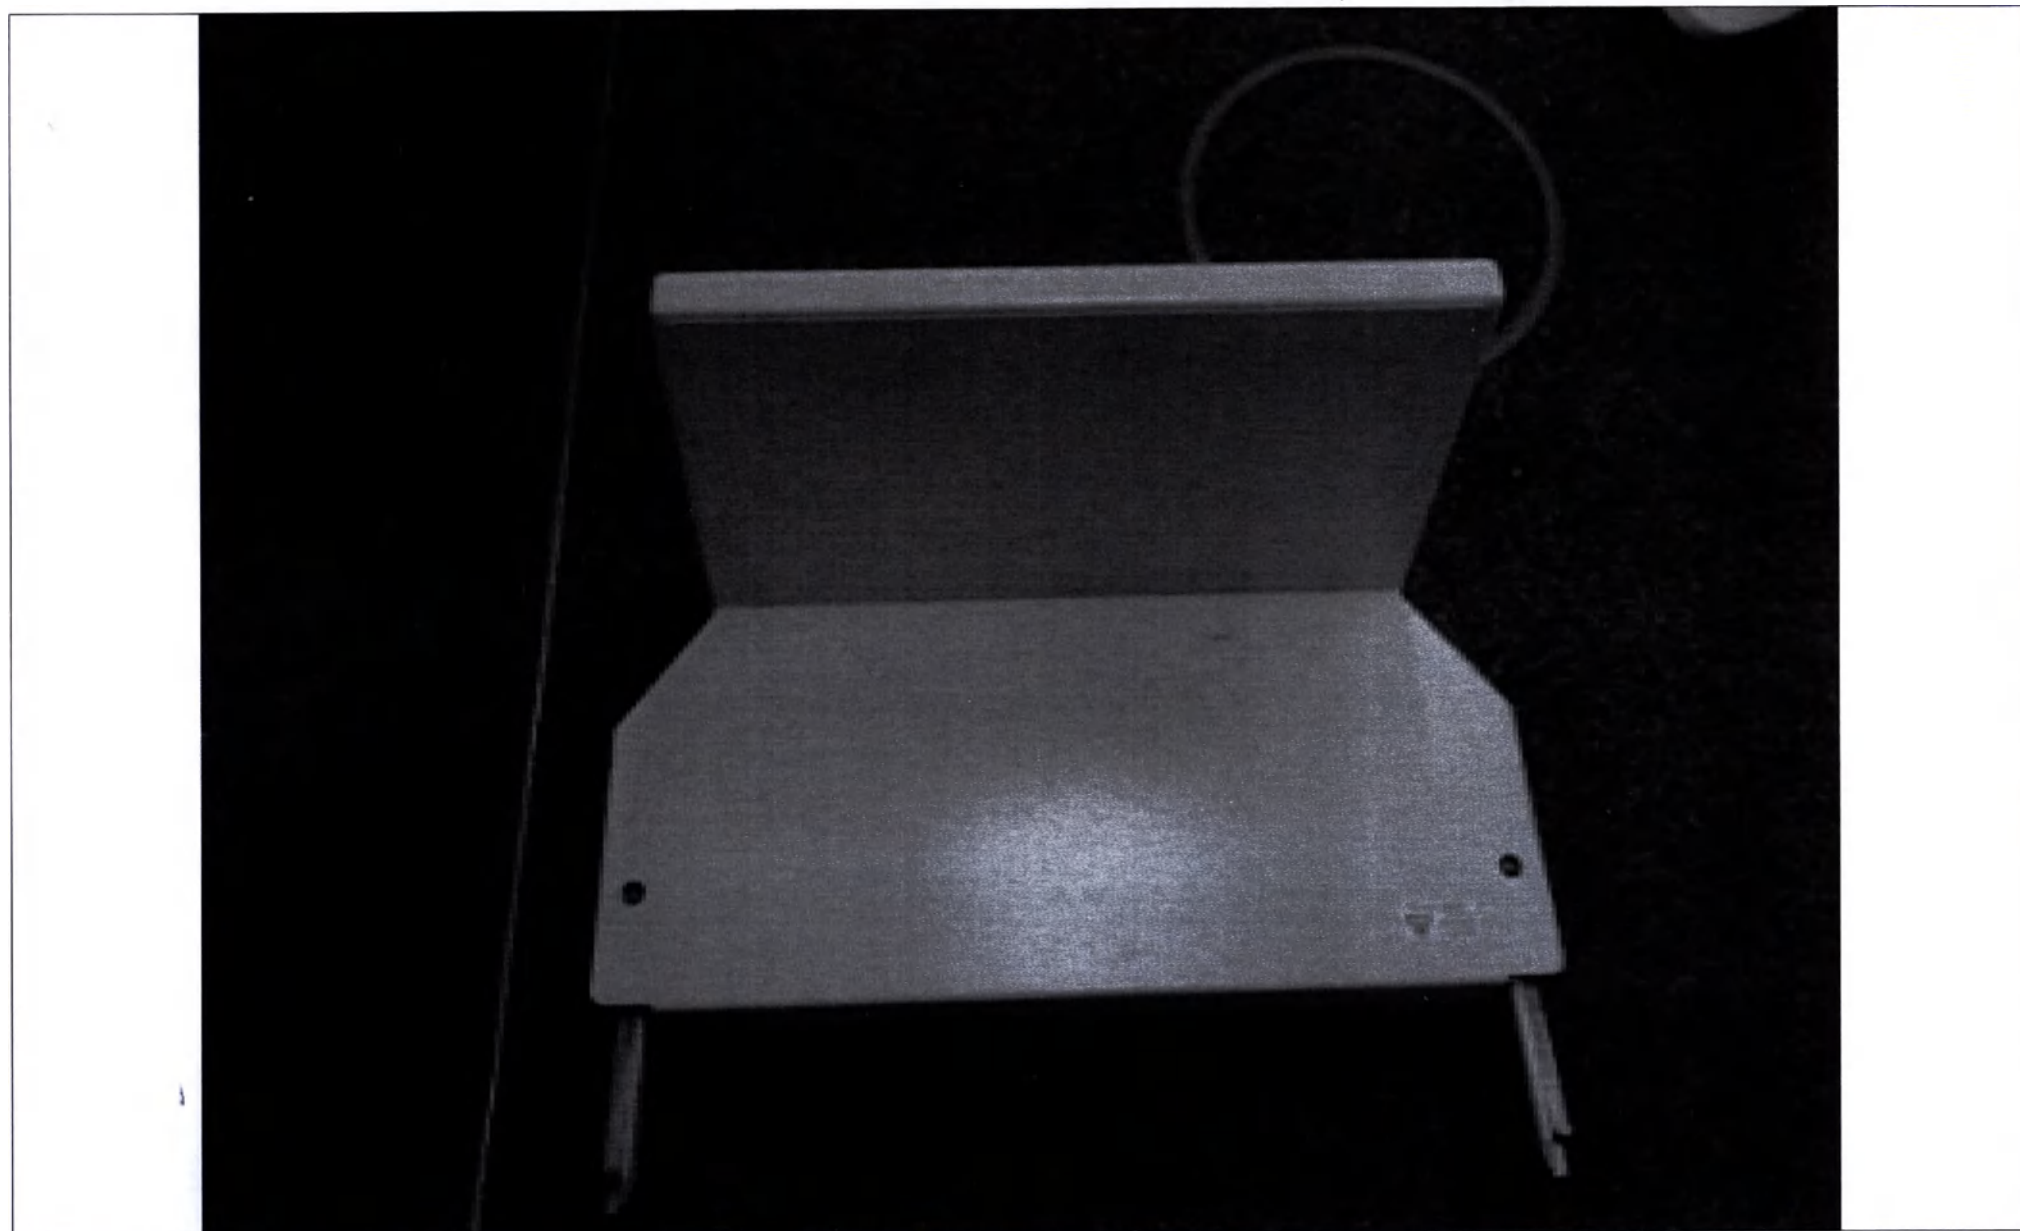

13. Подножка

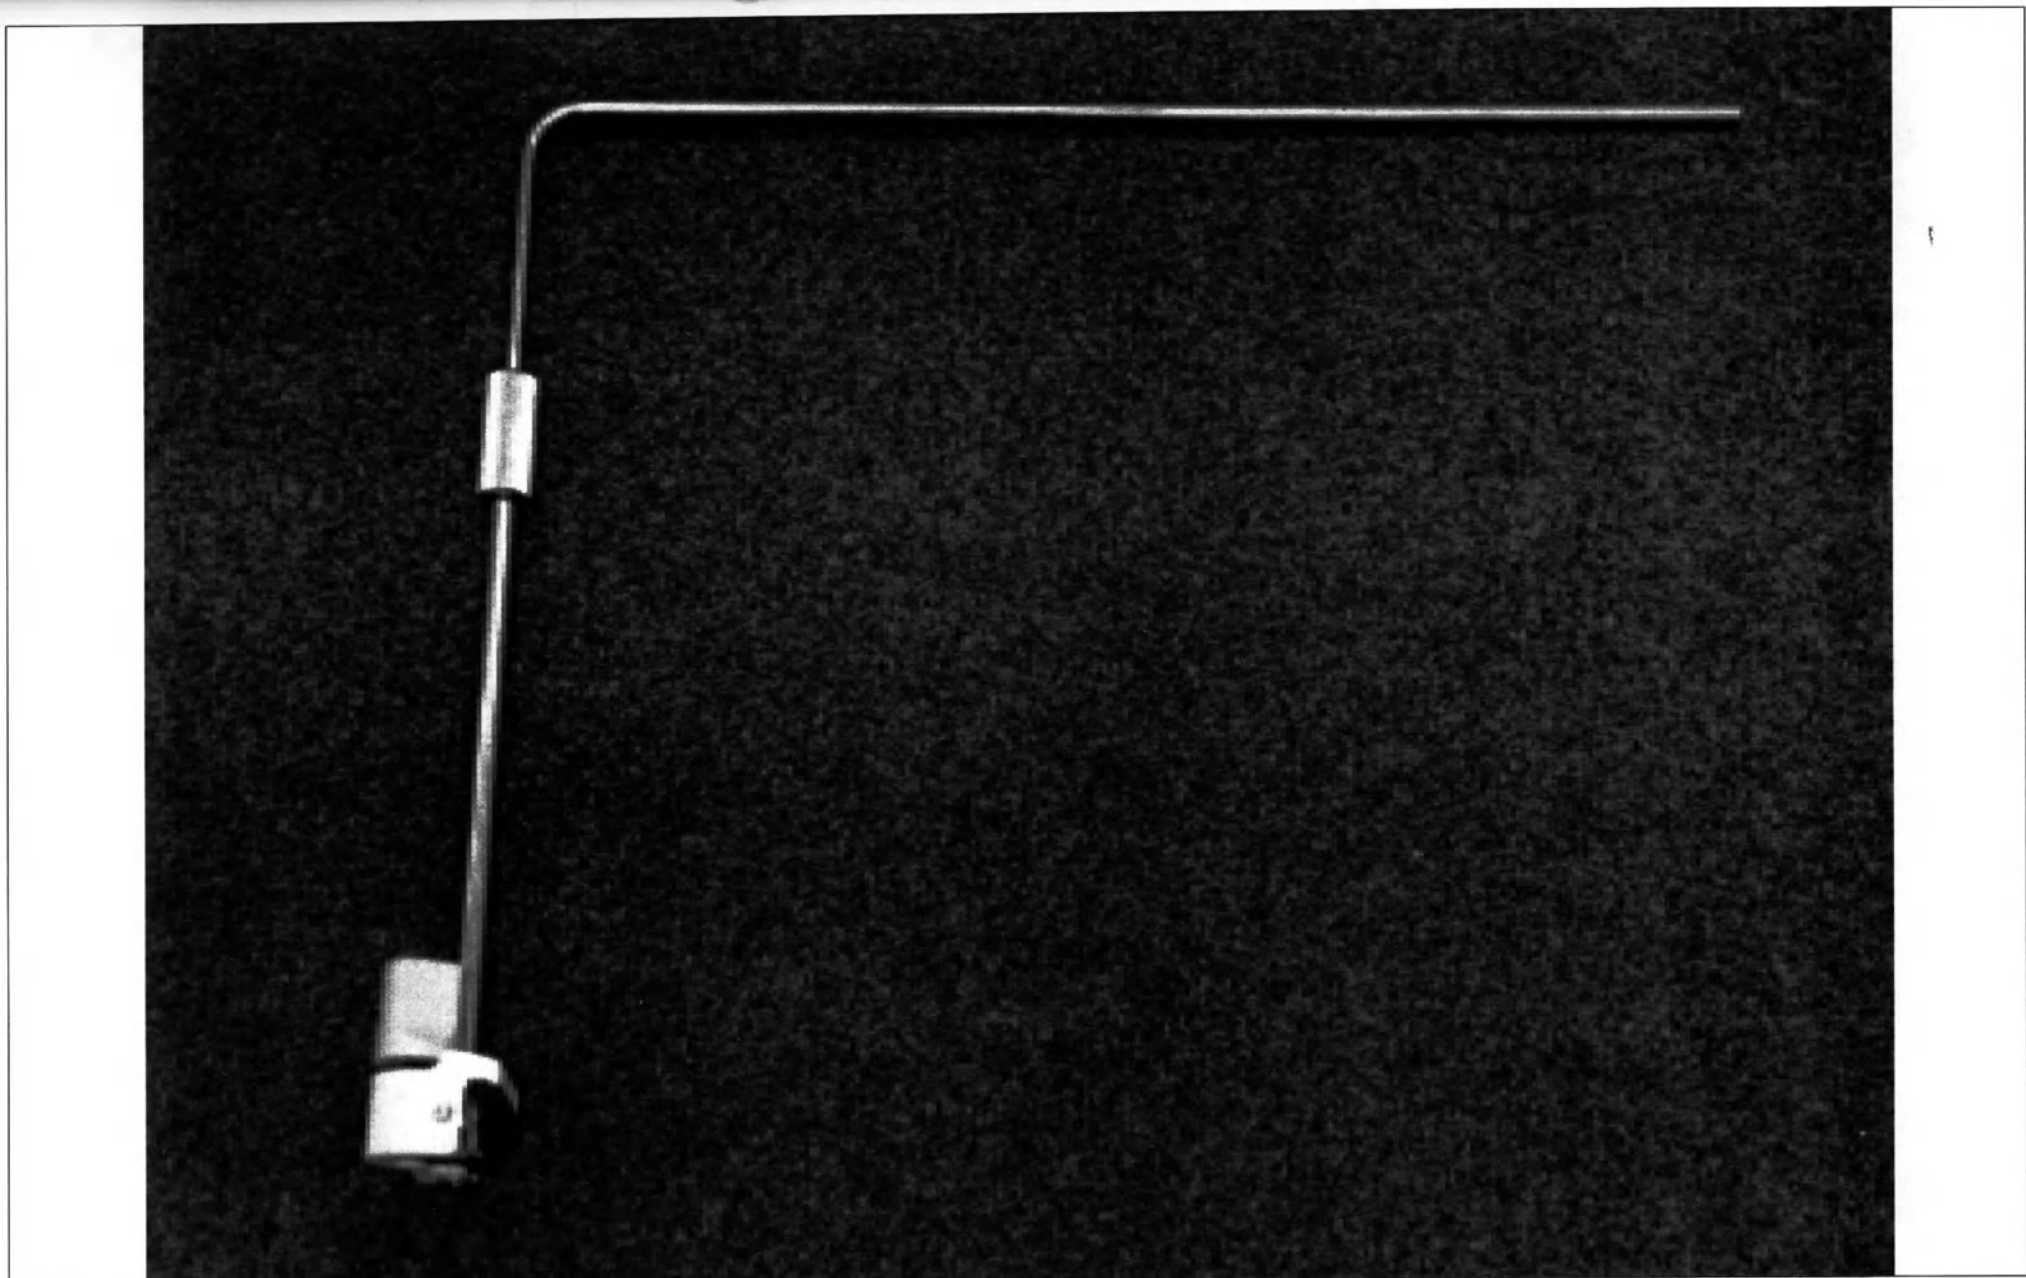

14. Держатель наркозной ширмы

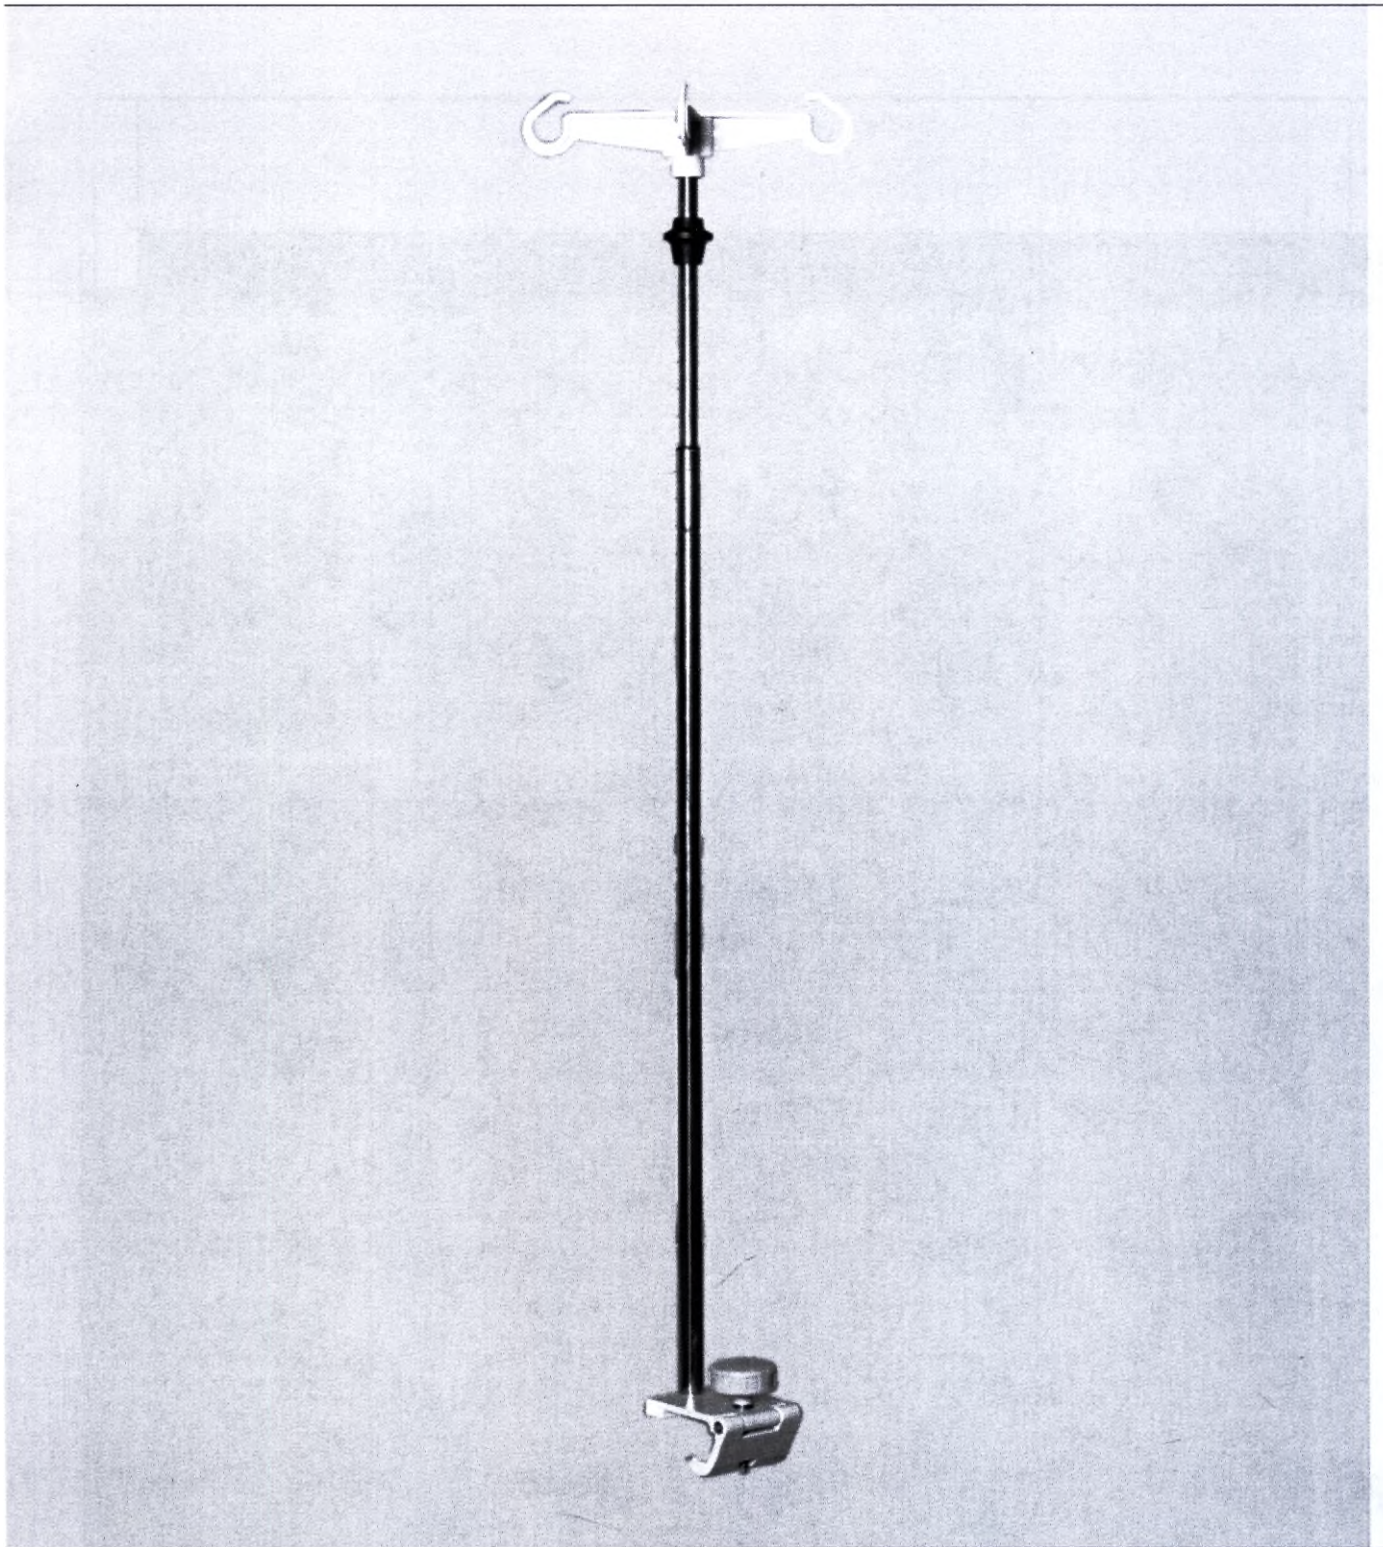

15. Кронштейн для бутылки инфузионной системы



16. Держатель кабеля для эндоскопии




17. Полка для эндоскопии.




18. Мониторный стол




19. Тележка для принадлежностей

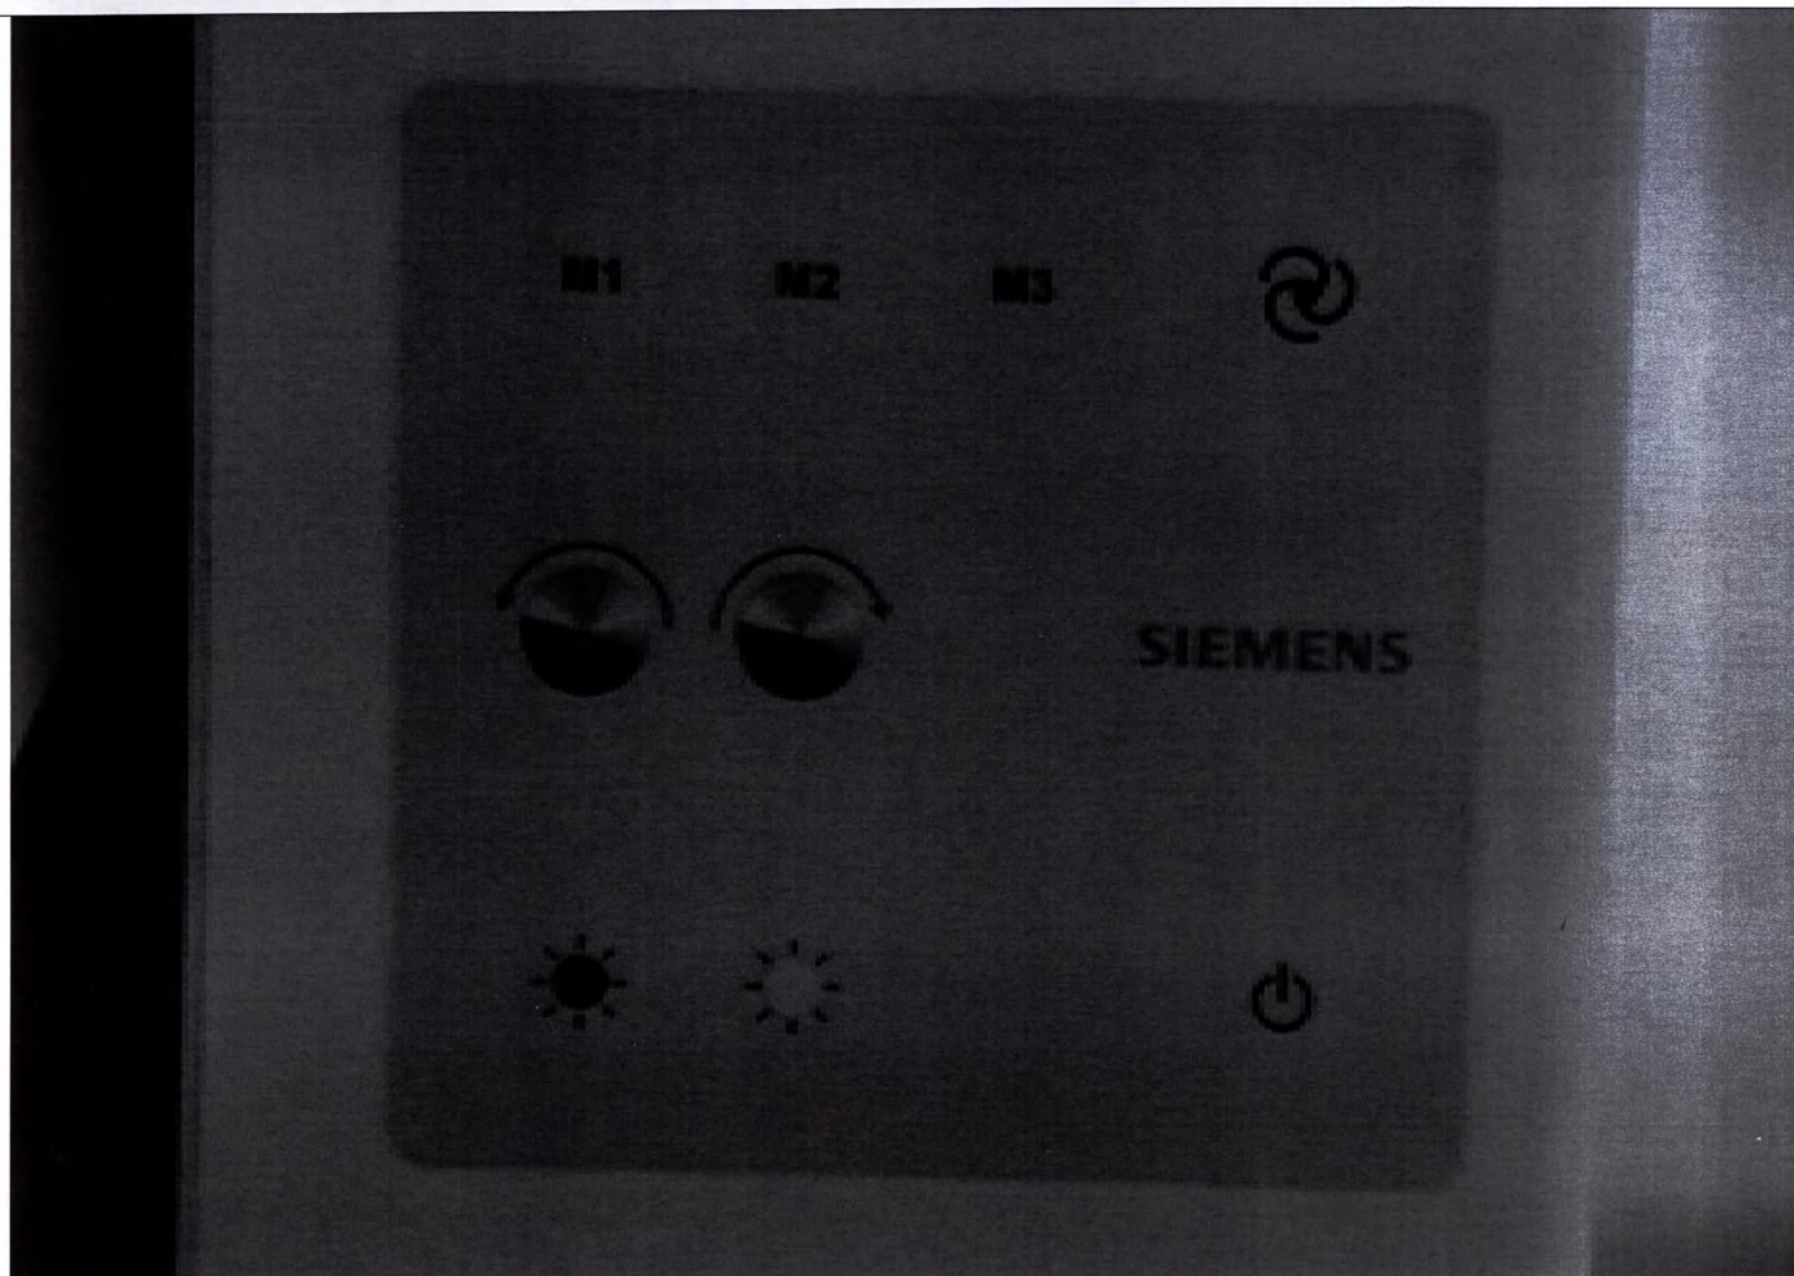


20. Панель с подсветкой "MoodLight".

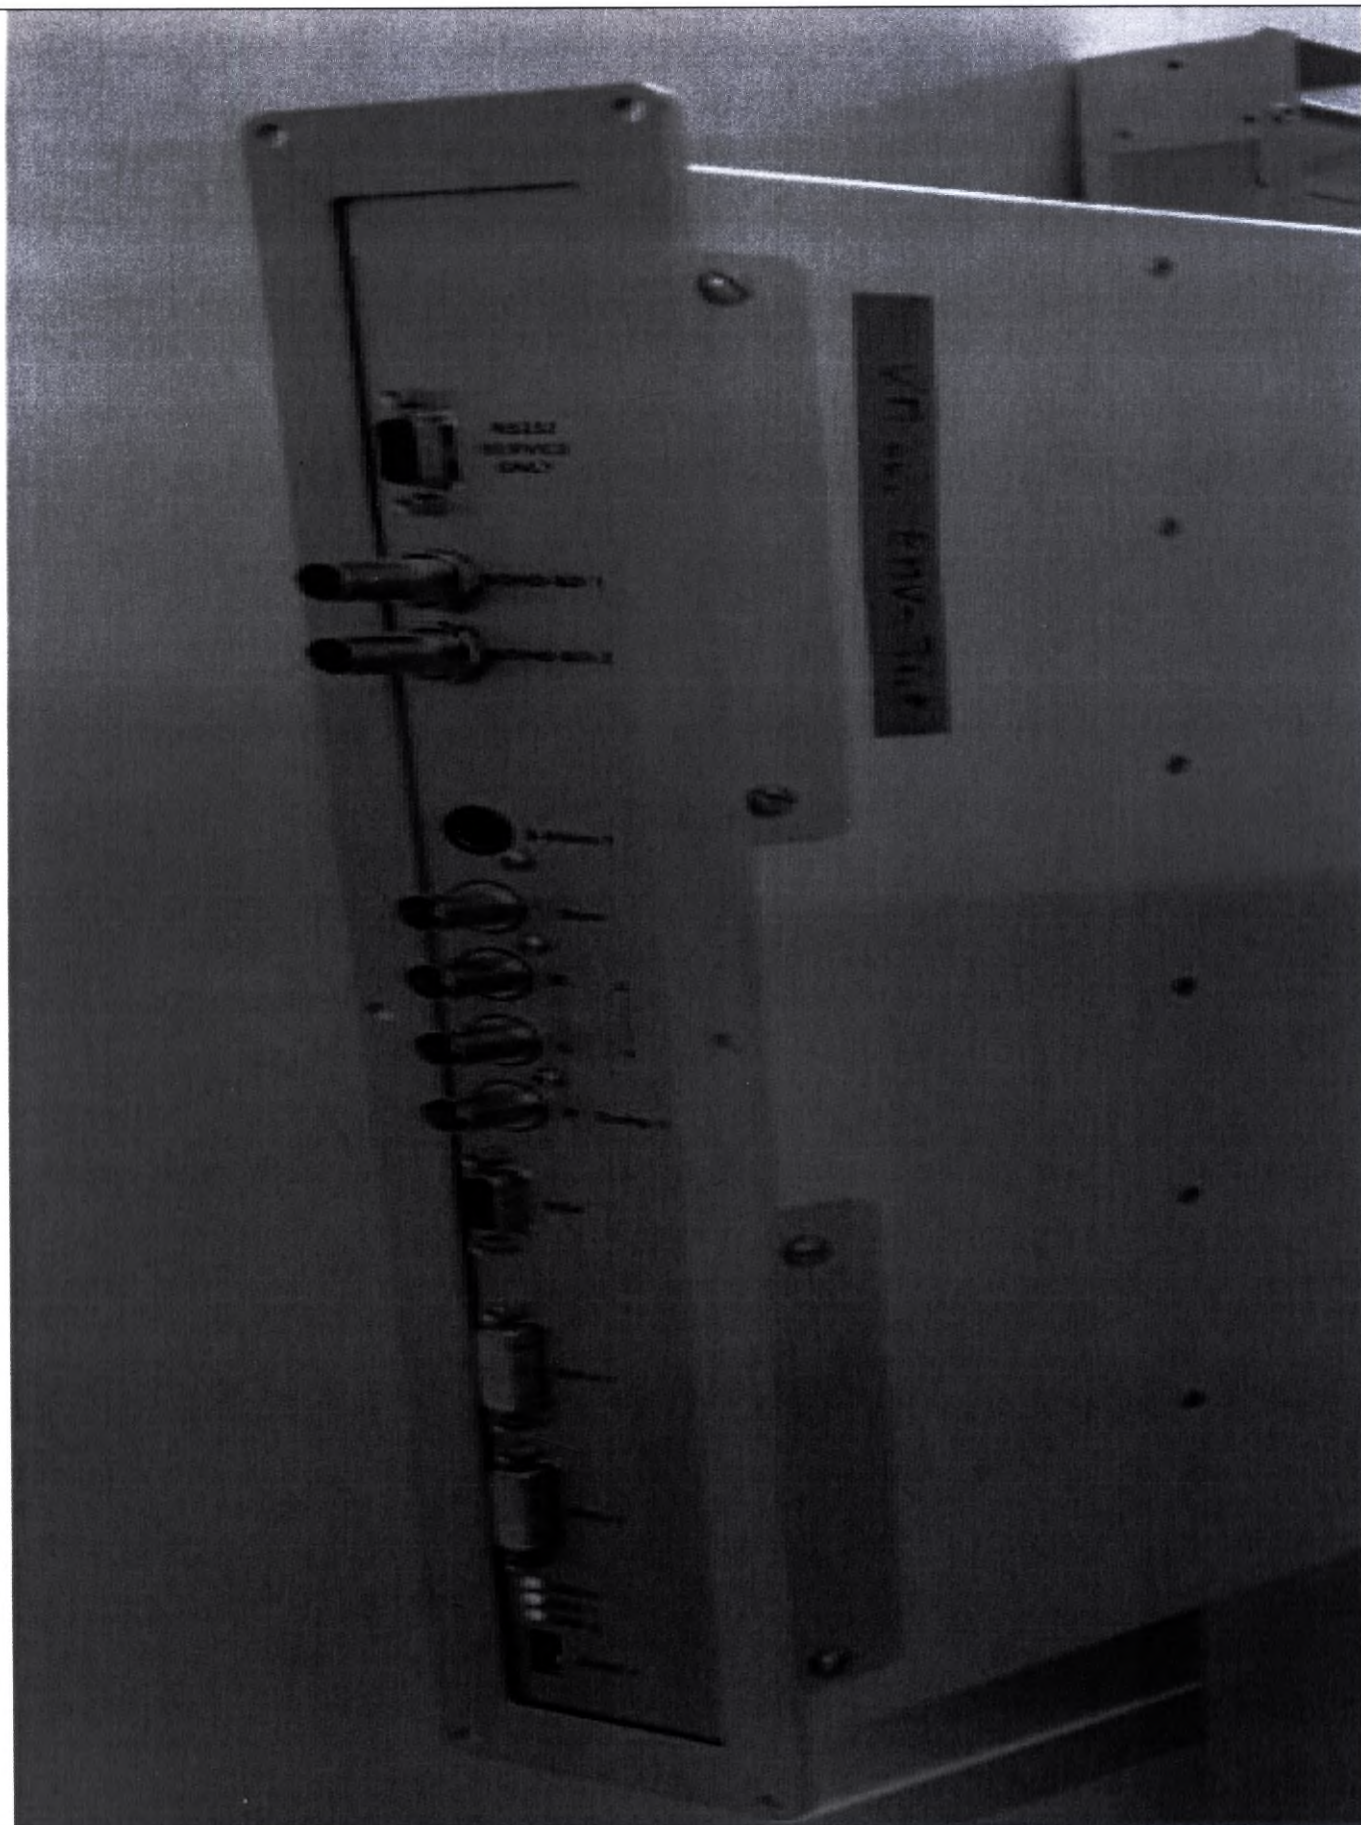


1. Диспетчер видеоизображения

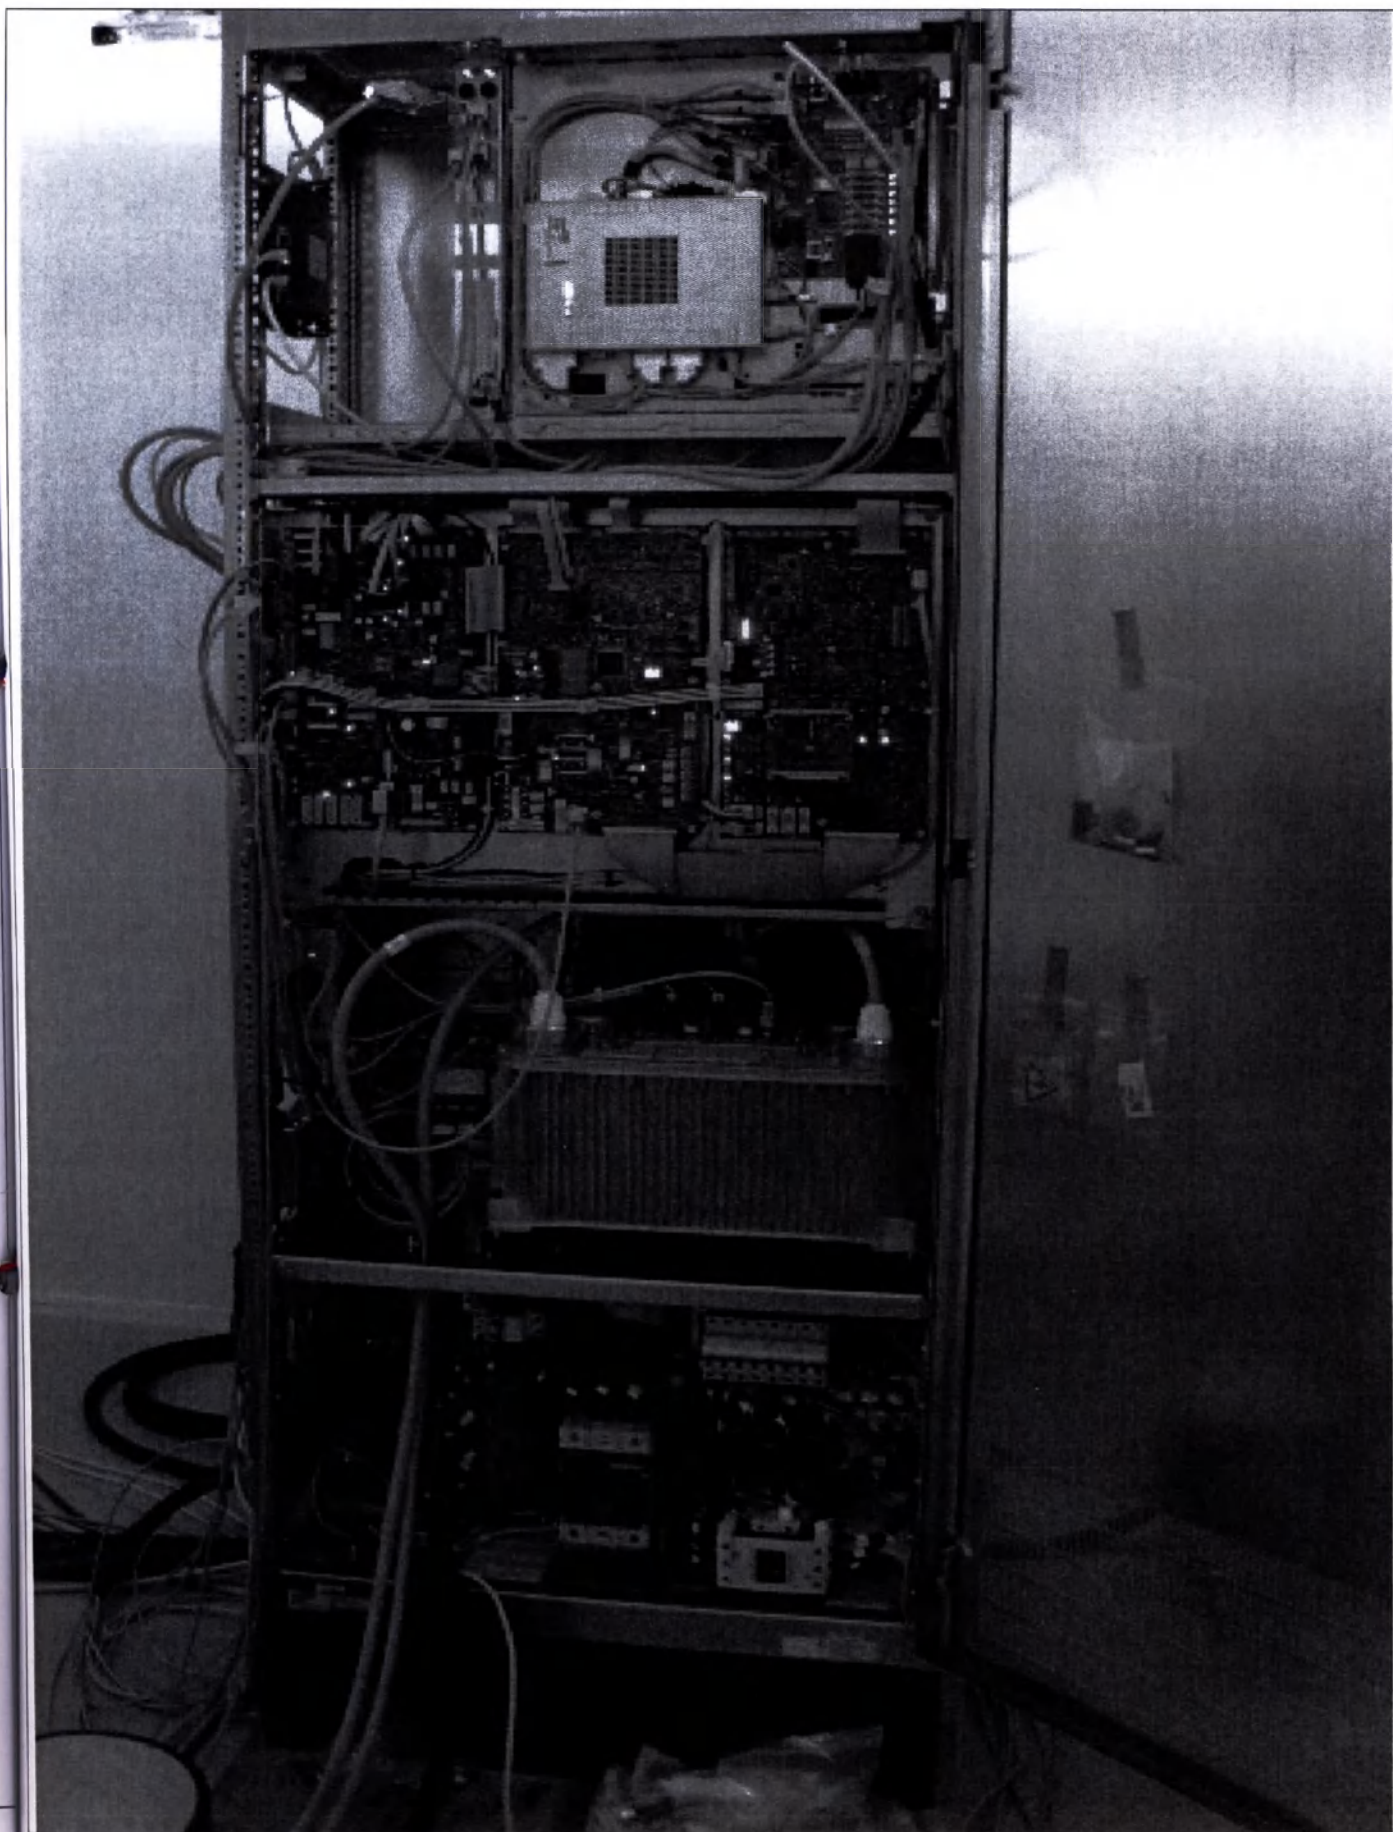


22. Отделение для хранения кабеля

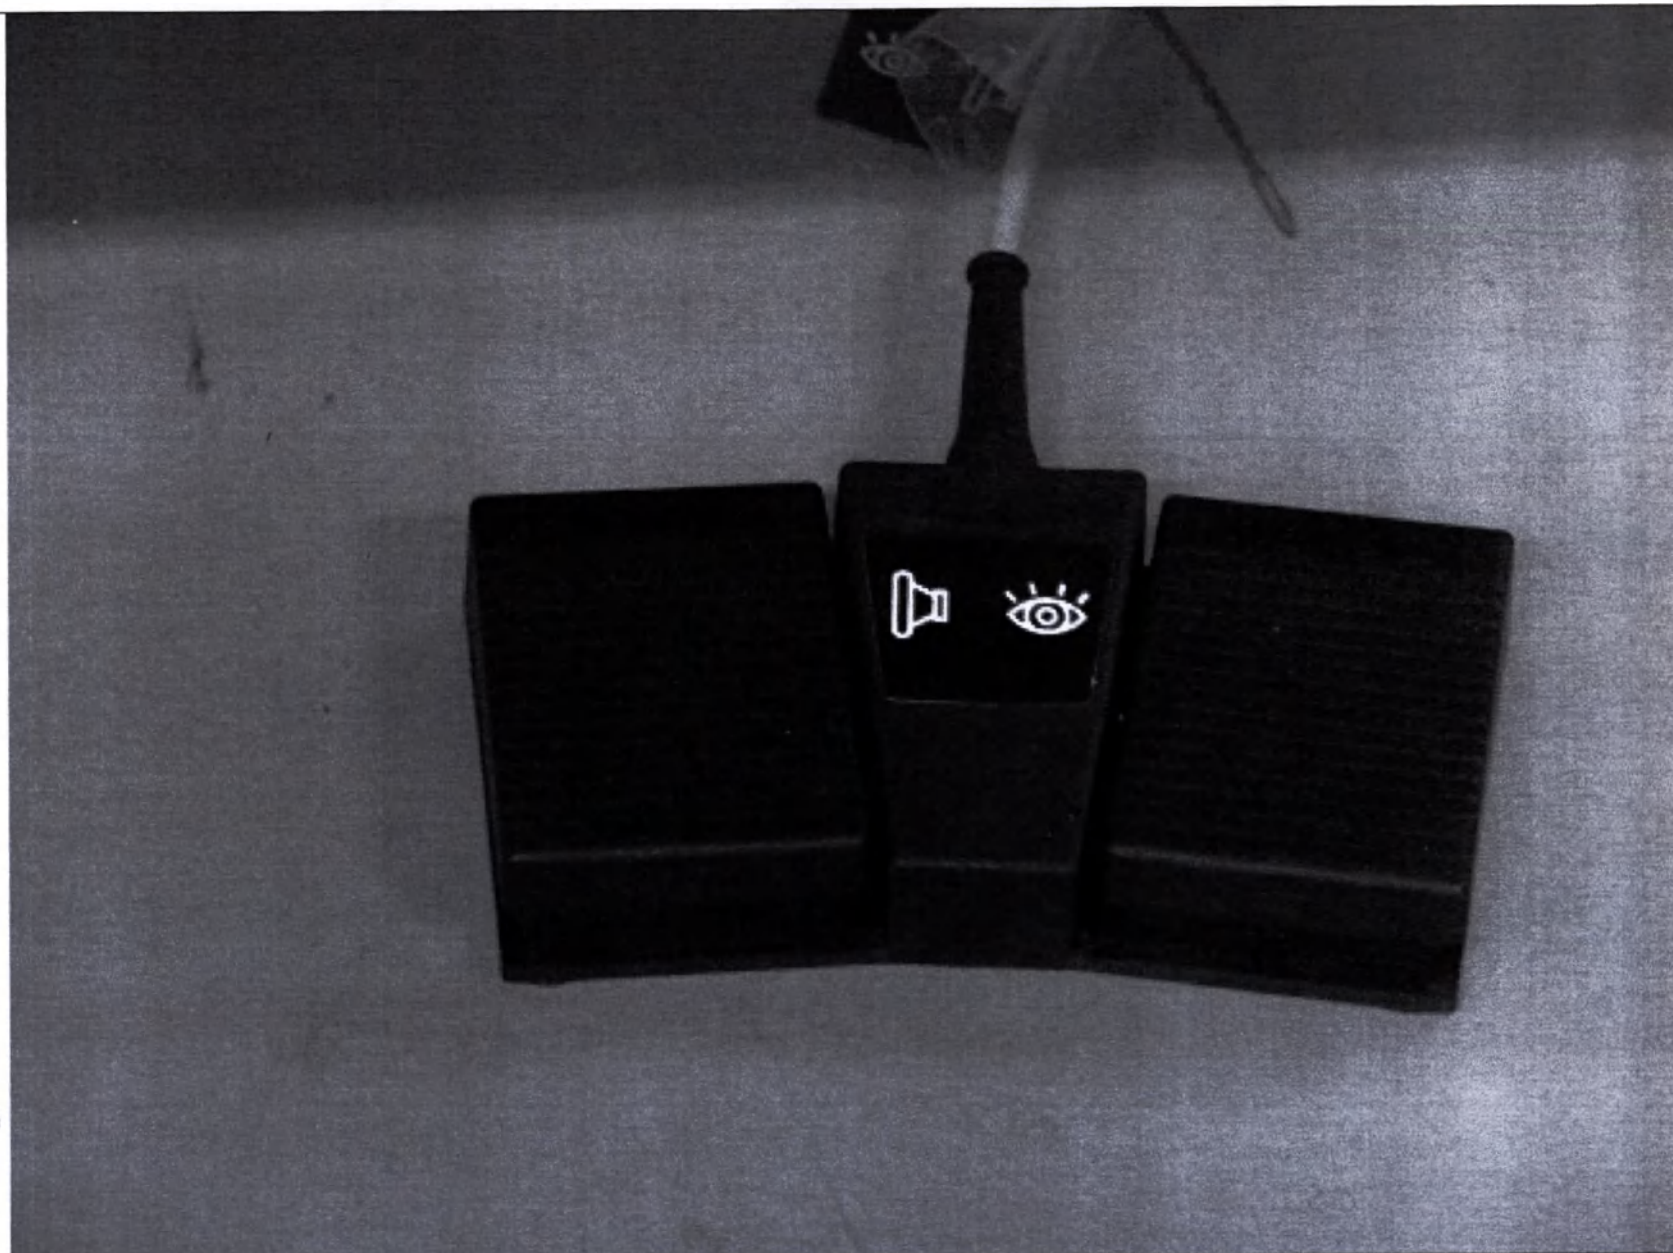


23. Педальный переключатель для рентгеноскопии/рентгенографии

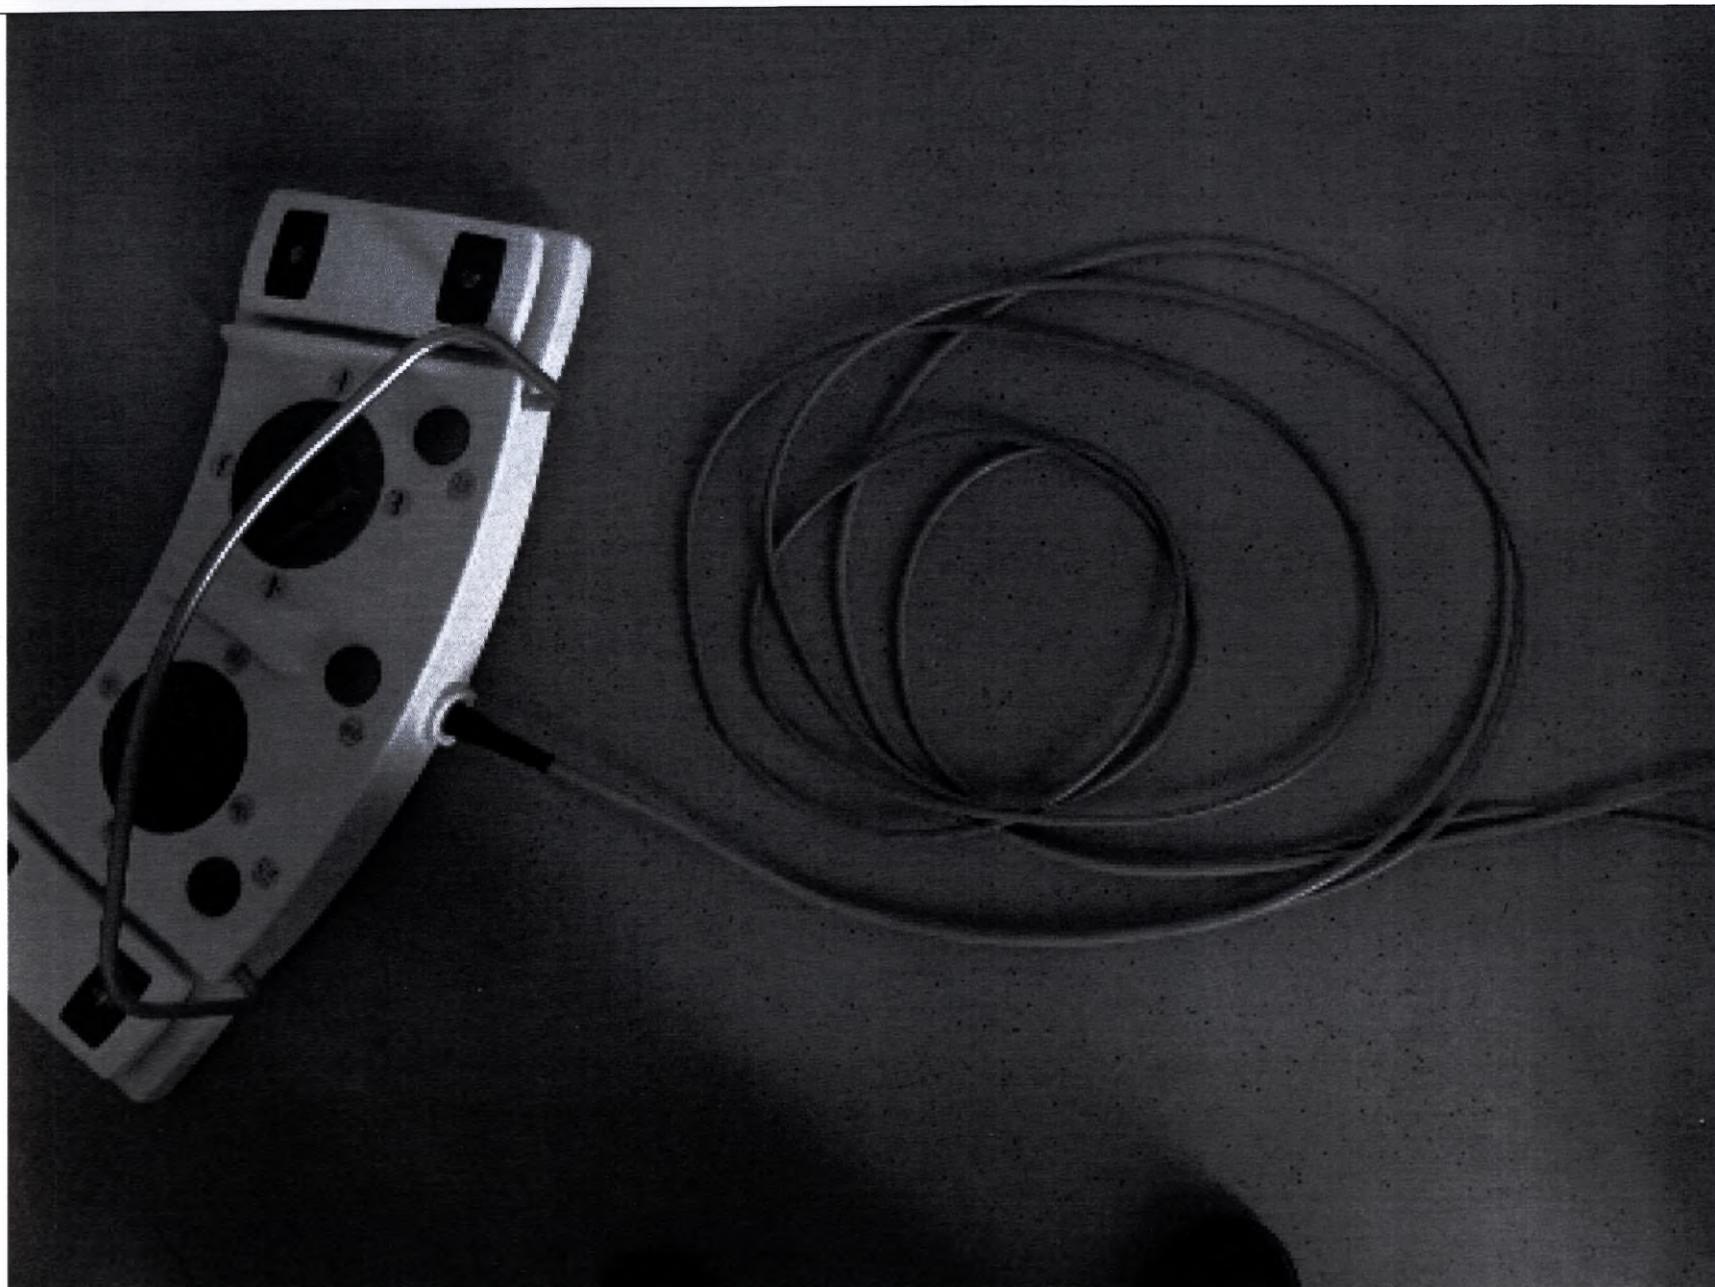


24. Удлинительный кабель для педального переключателя

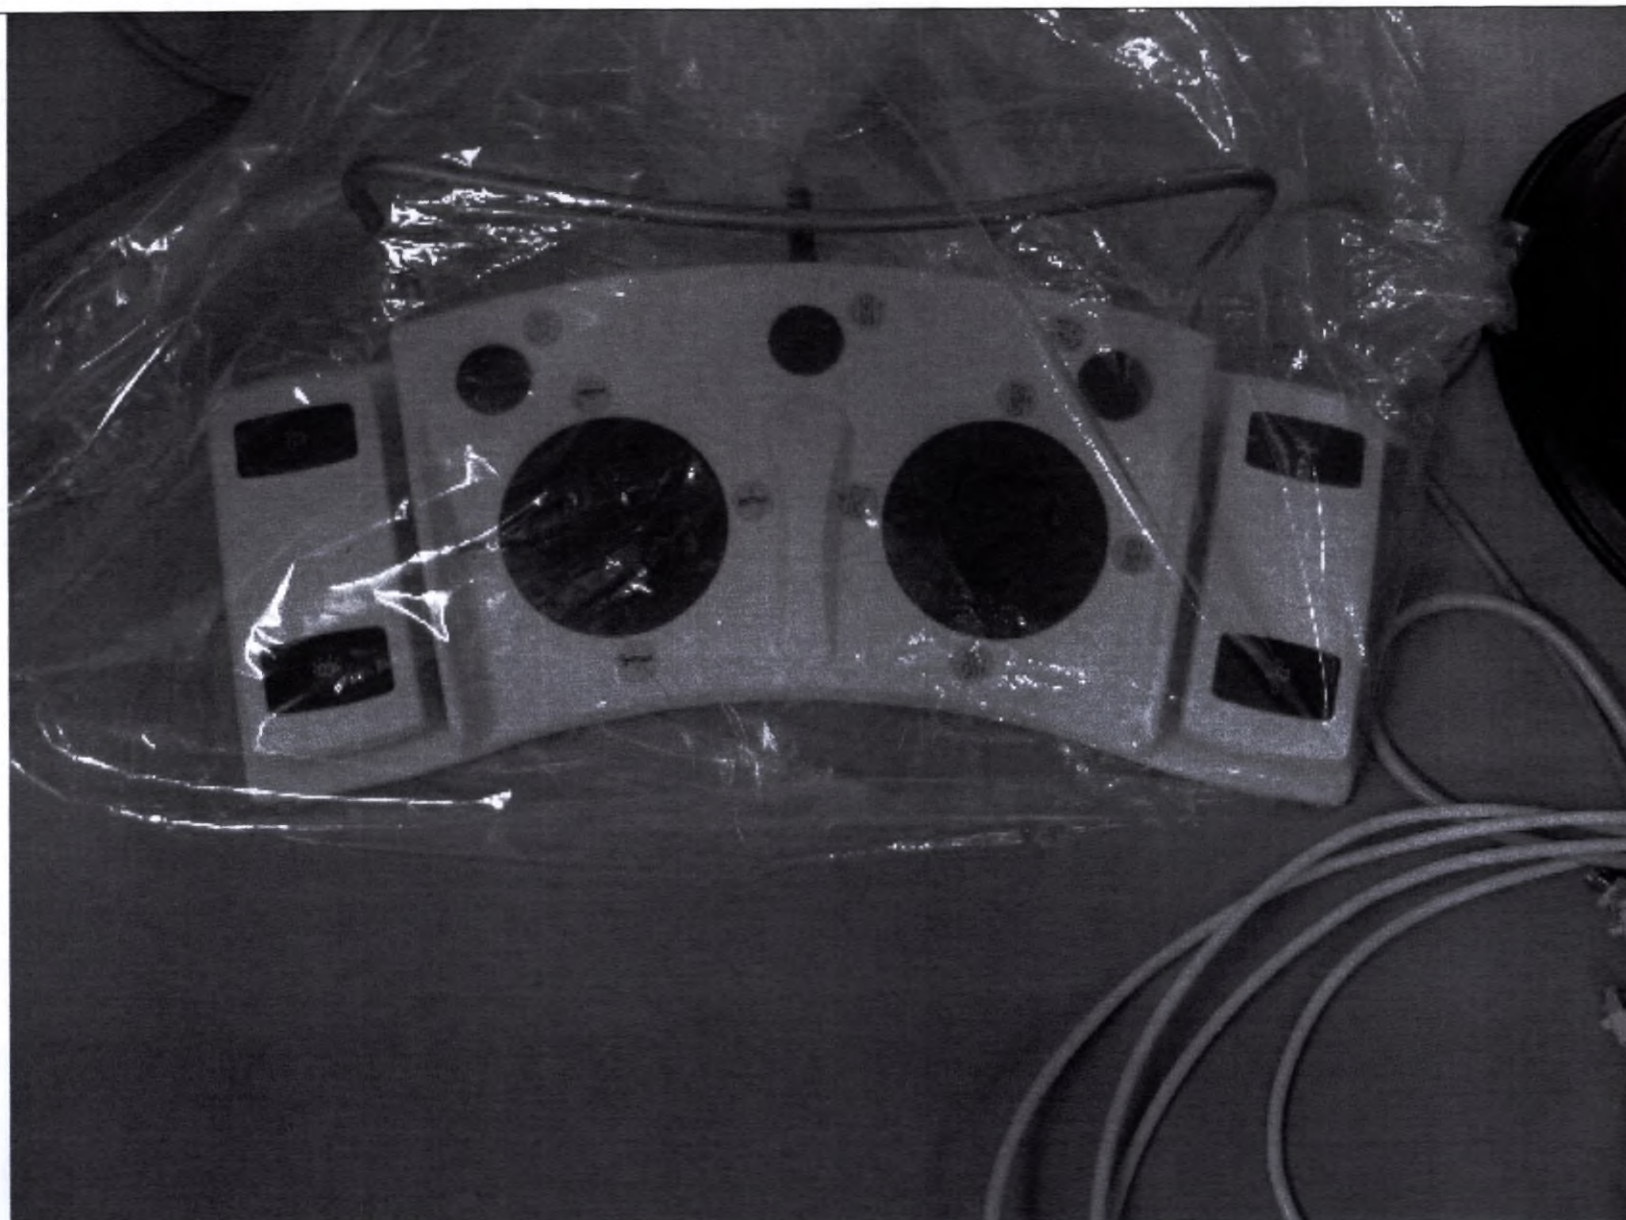

25. Многофункциональный педальный переключатель "Advanced".

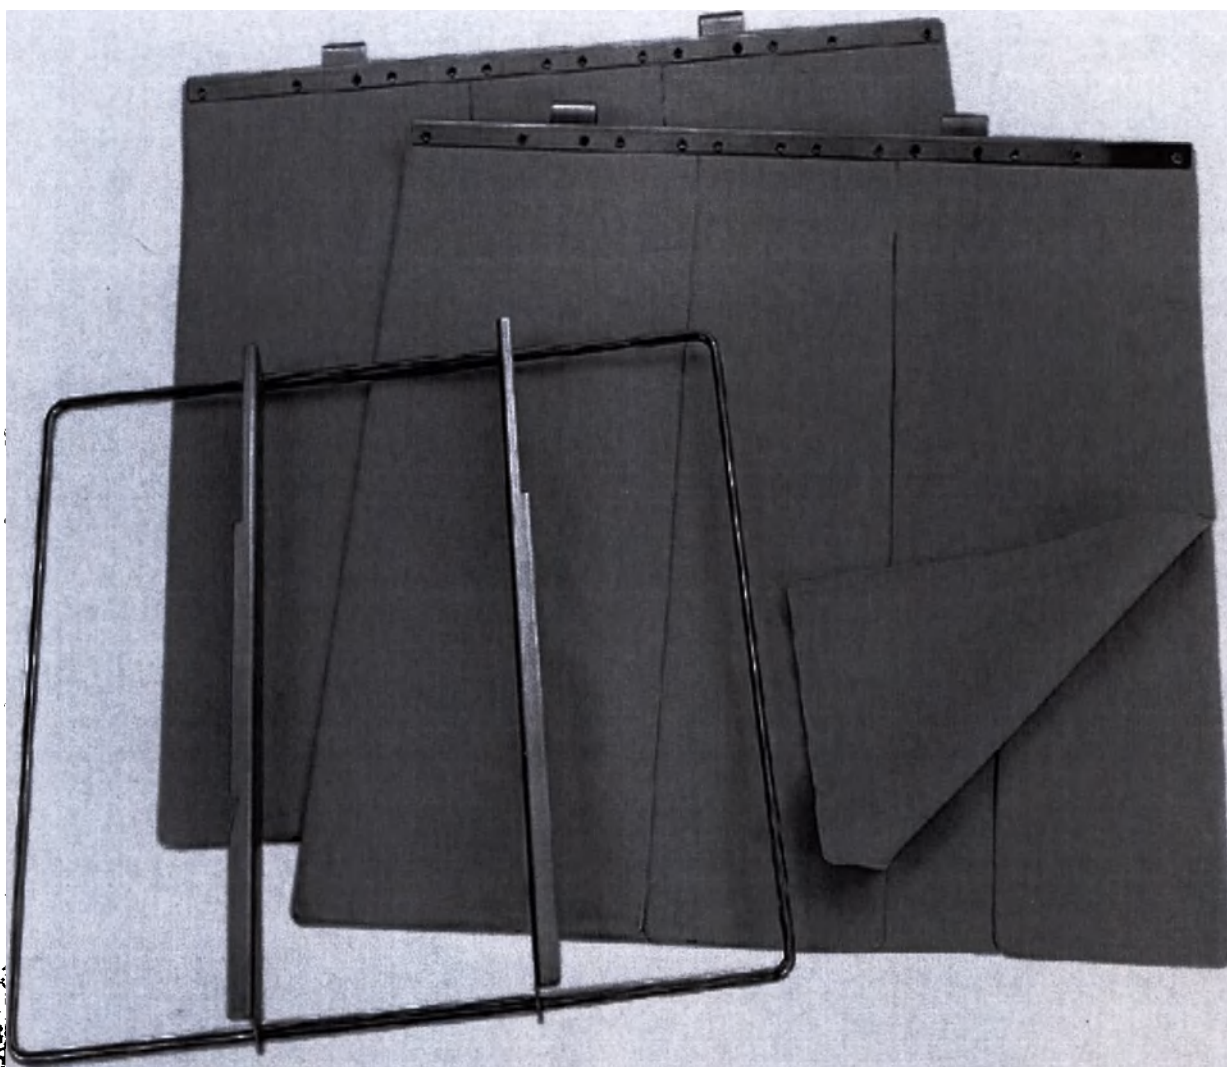


Радиационная защита, съемная

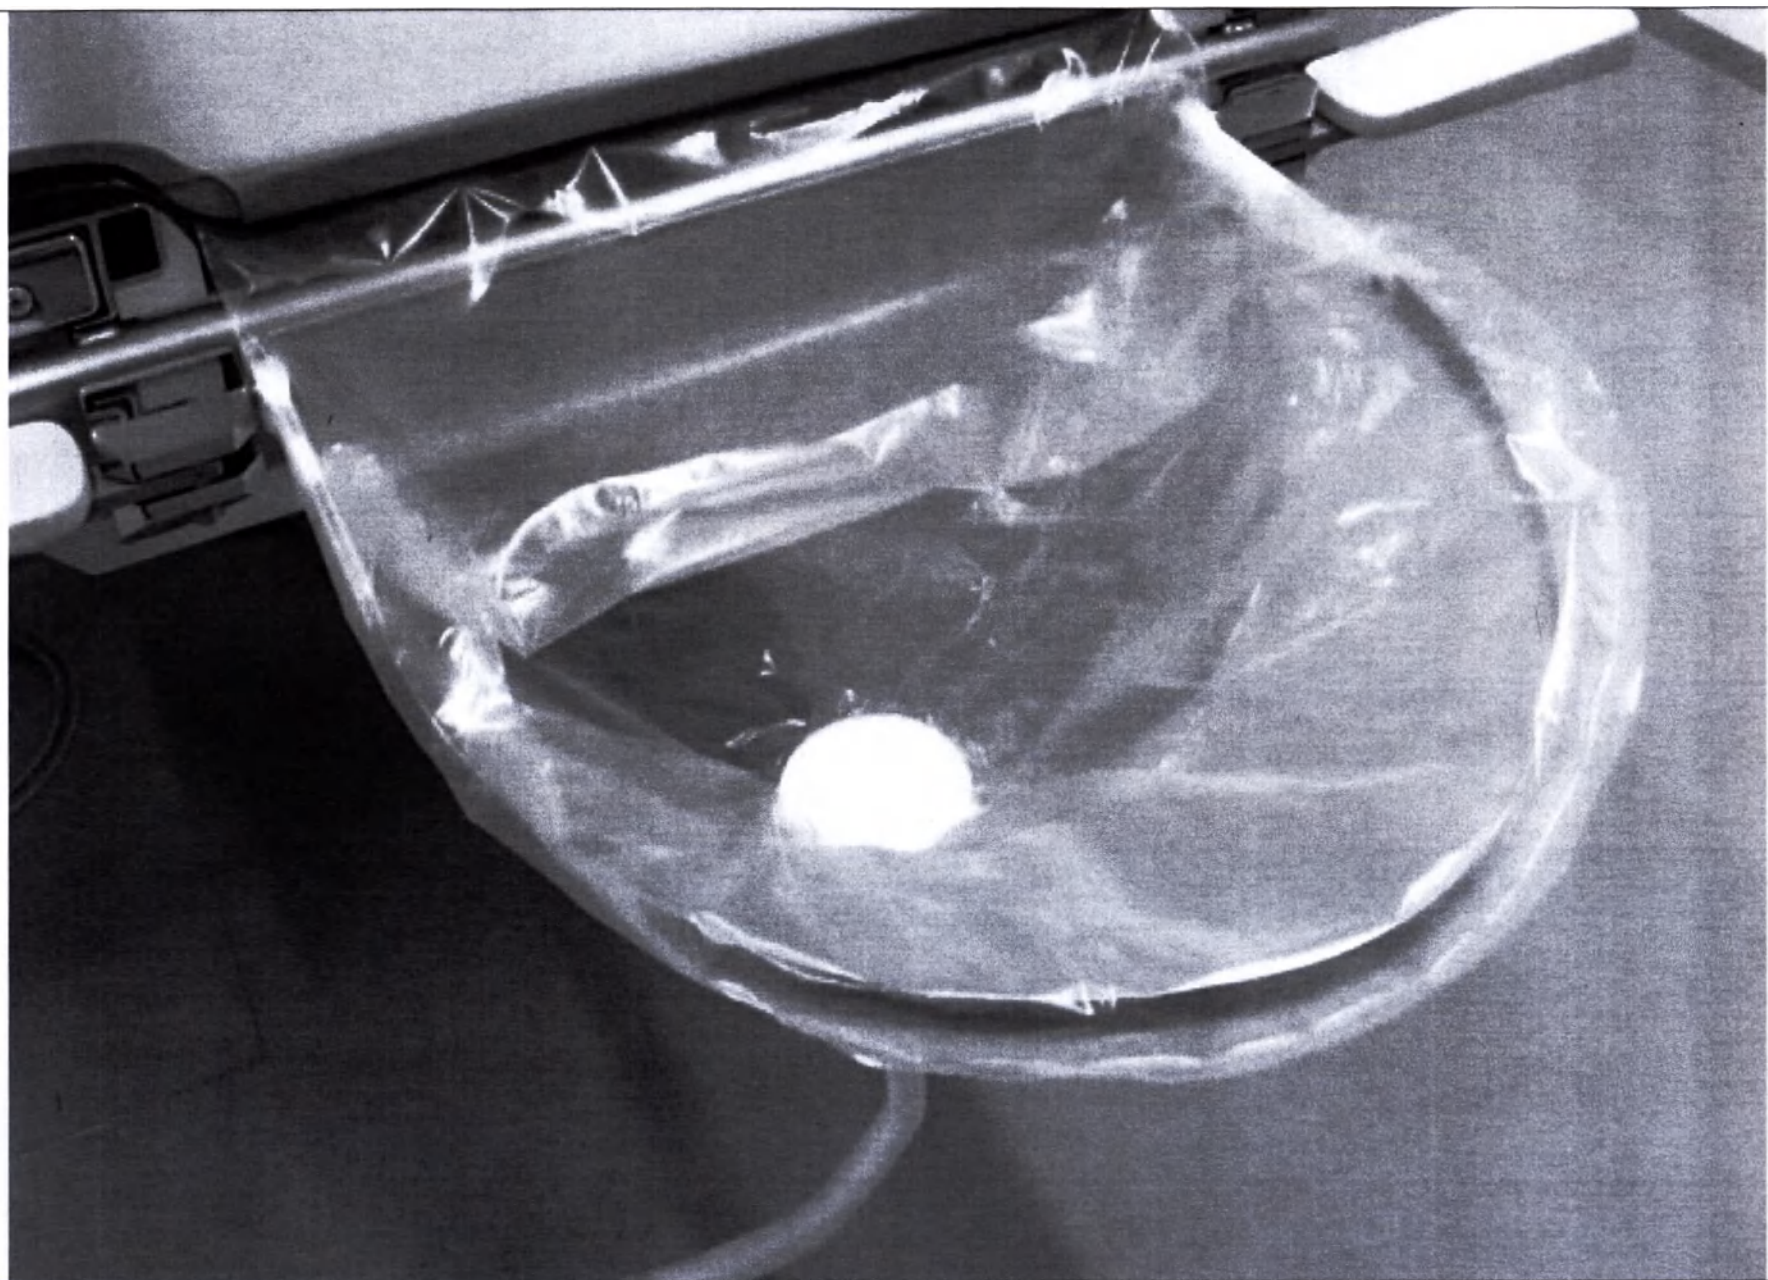


27. Подвеска дренажного мешка




28. Фиксатор рук пациента

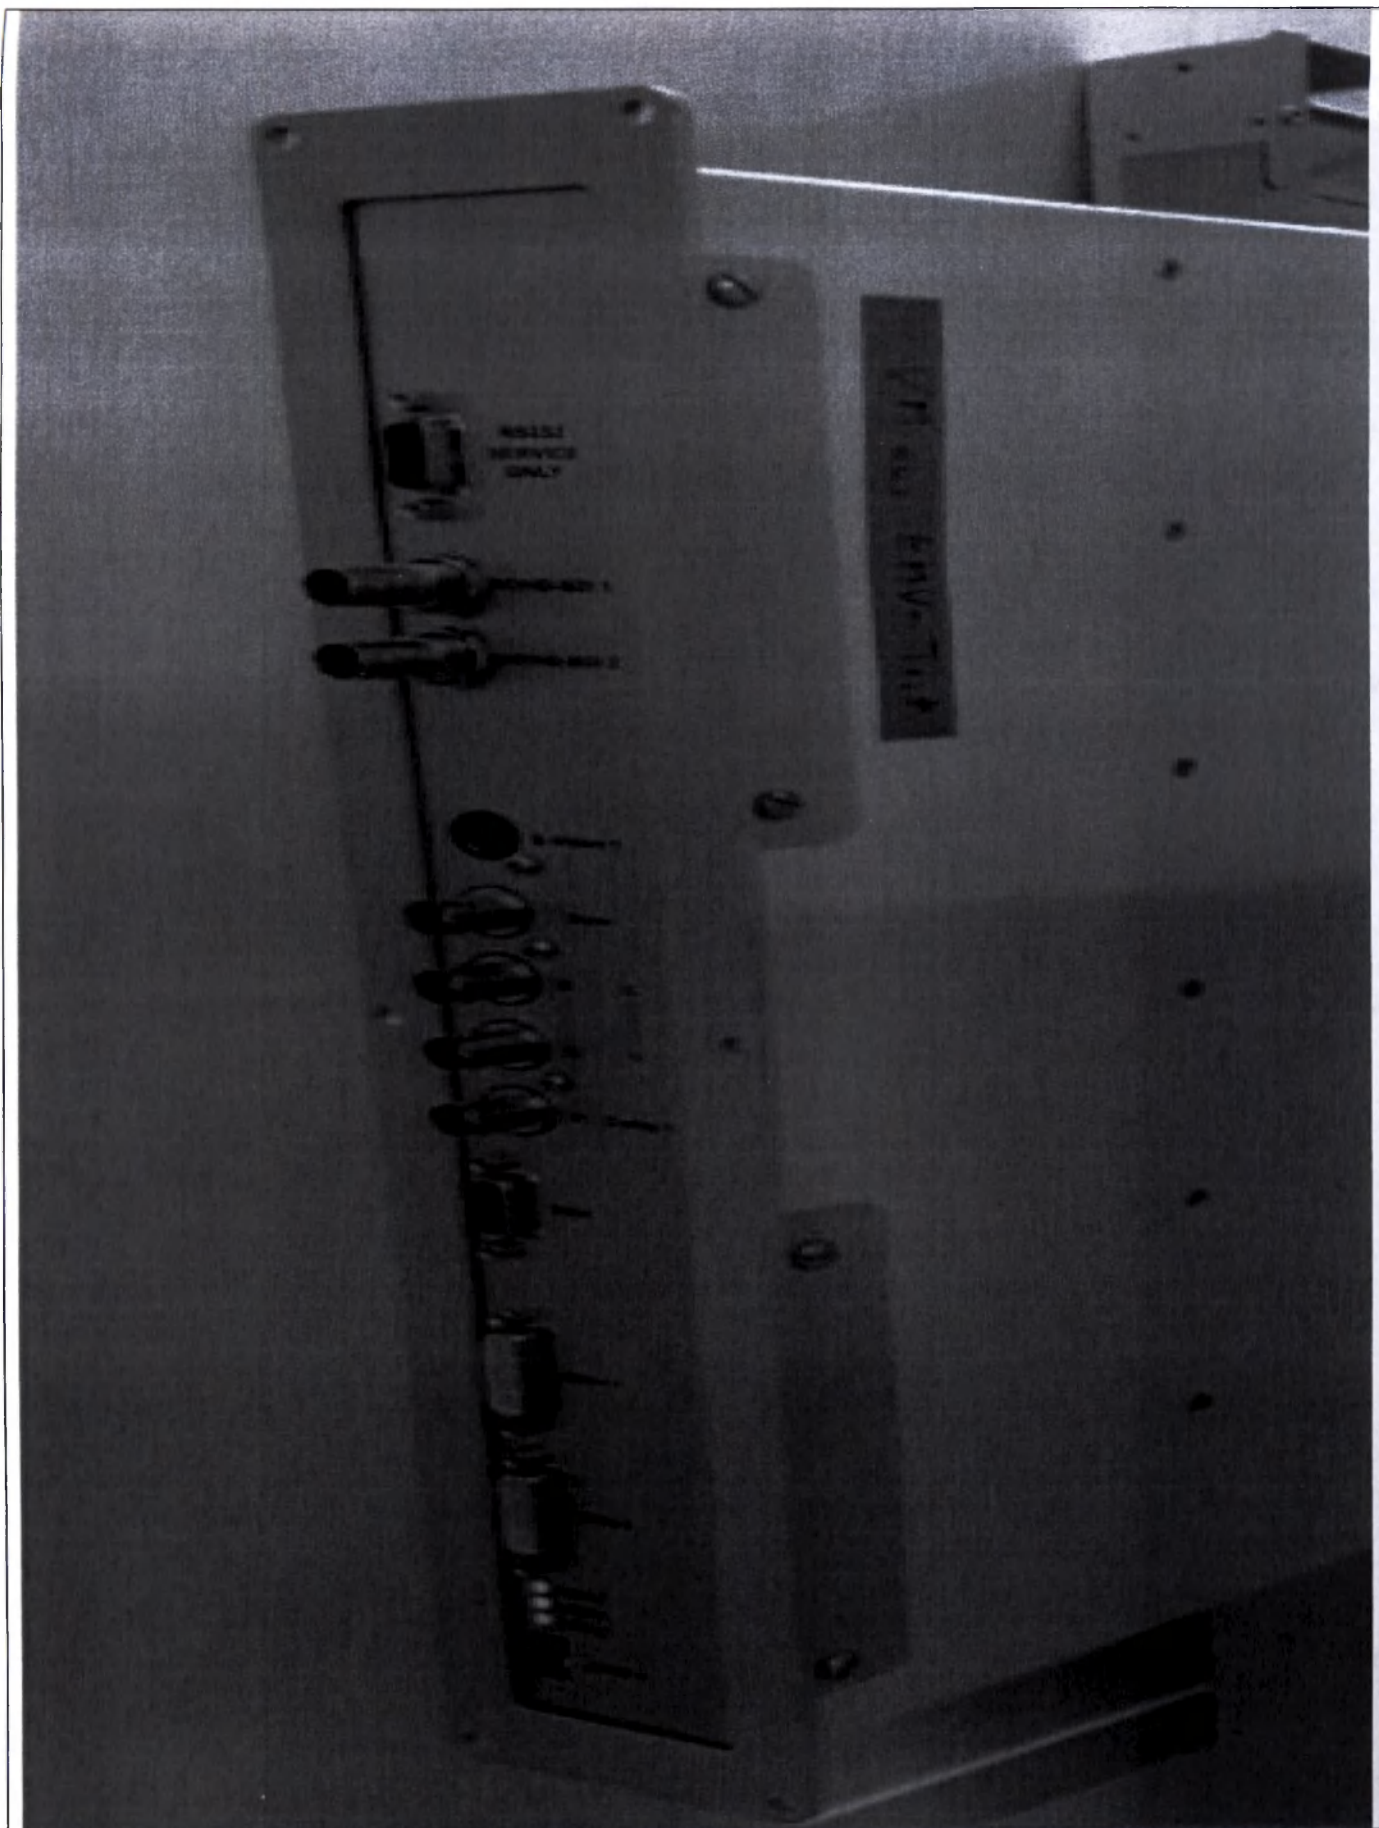


29. Диспетчер видеоизображений уродинамики

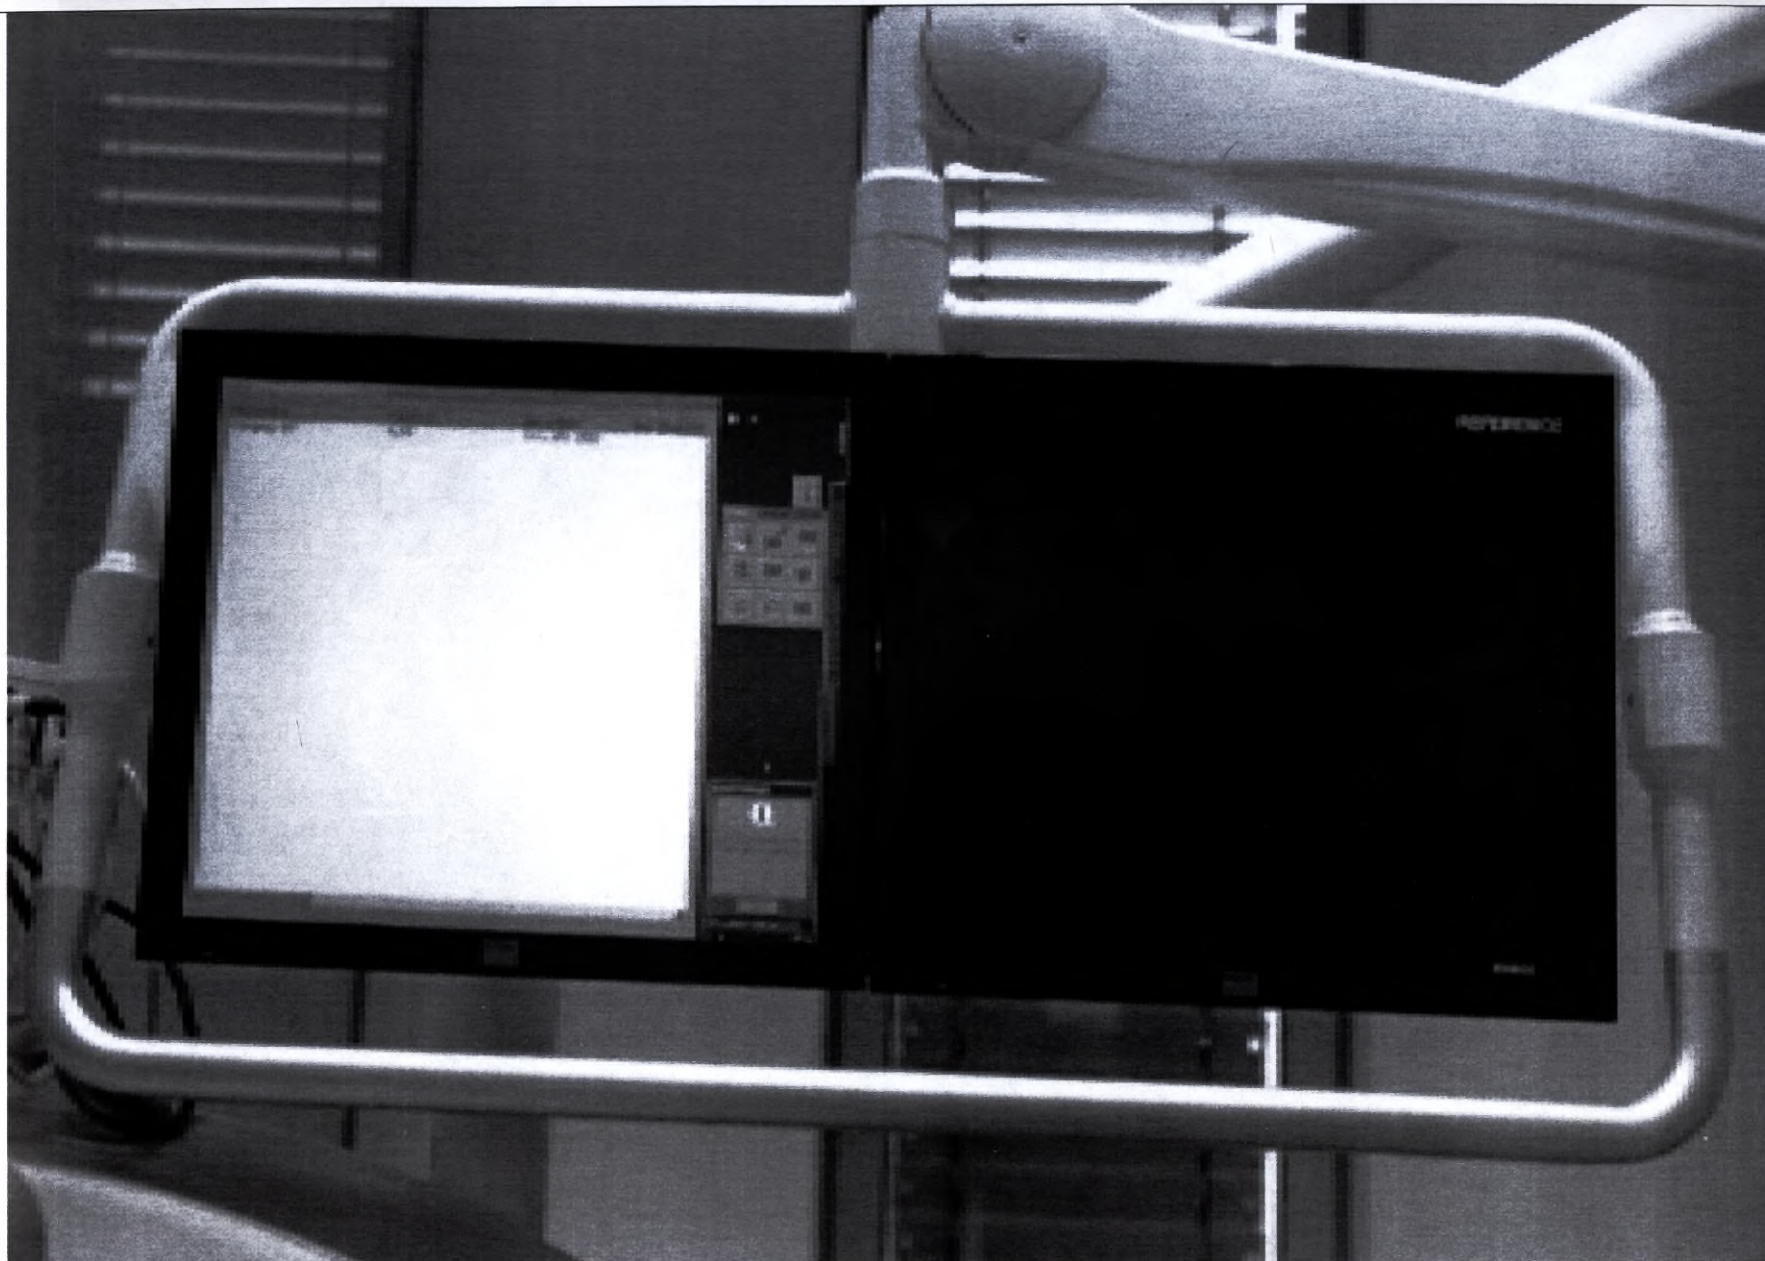


30. Монитор для контрольного/эндоскопического/ультразвукового сигнала.

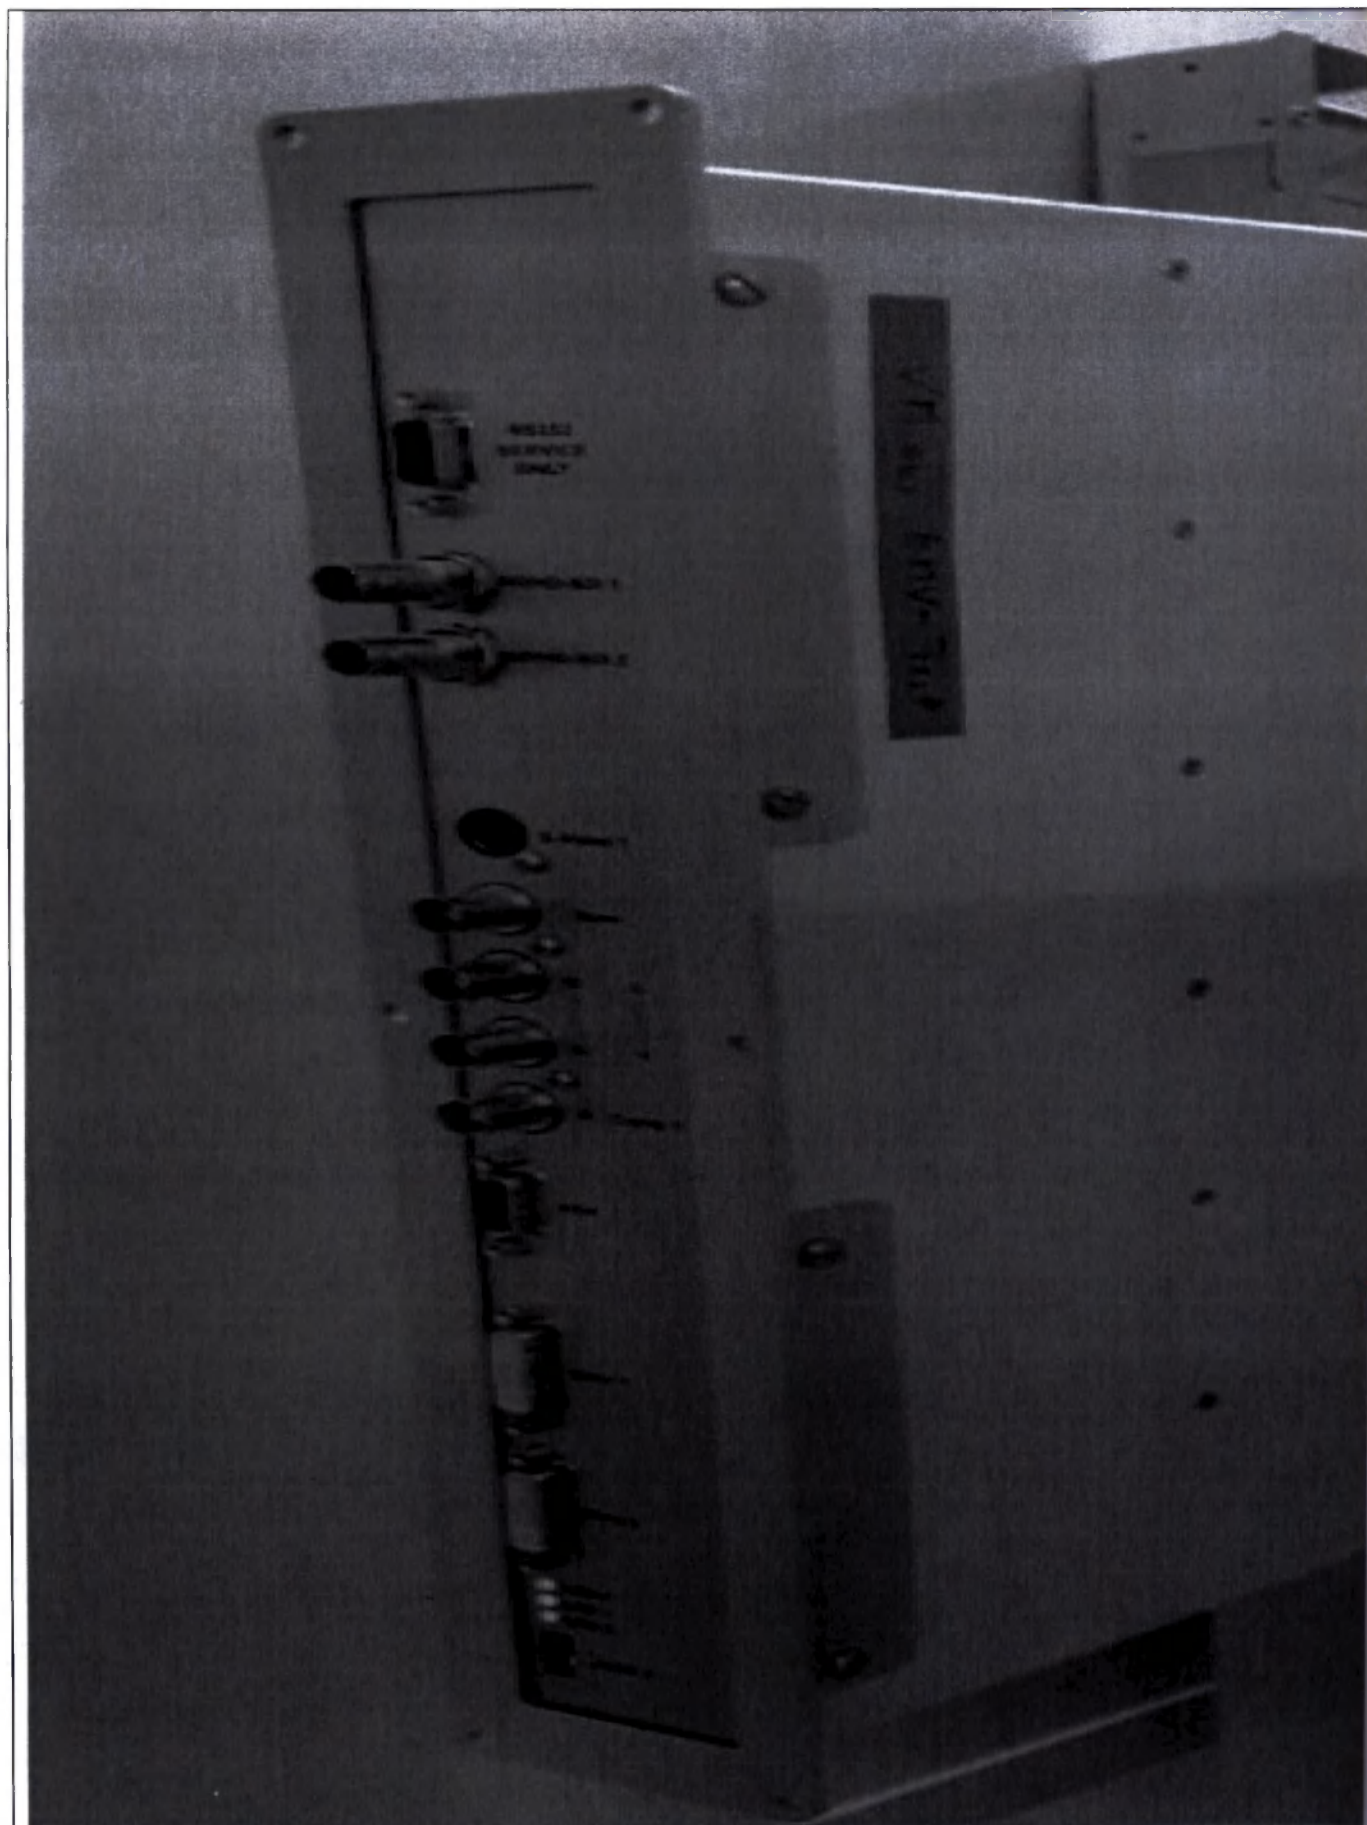


31. Выход диспетчера видеоизображения

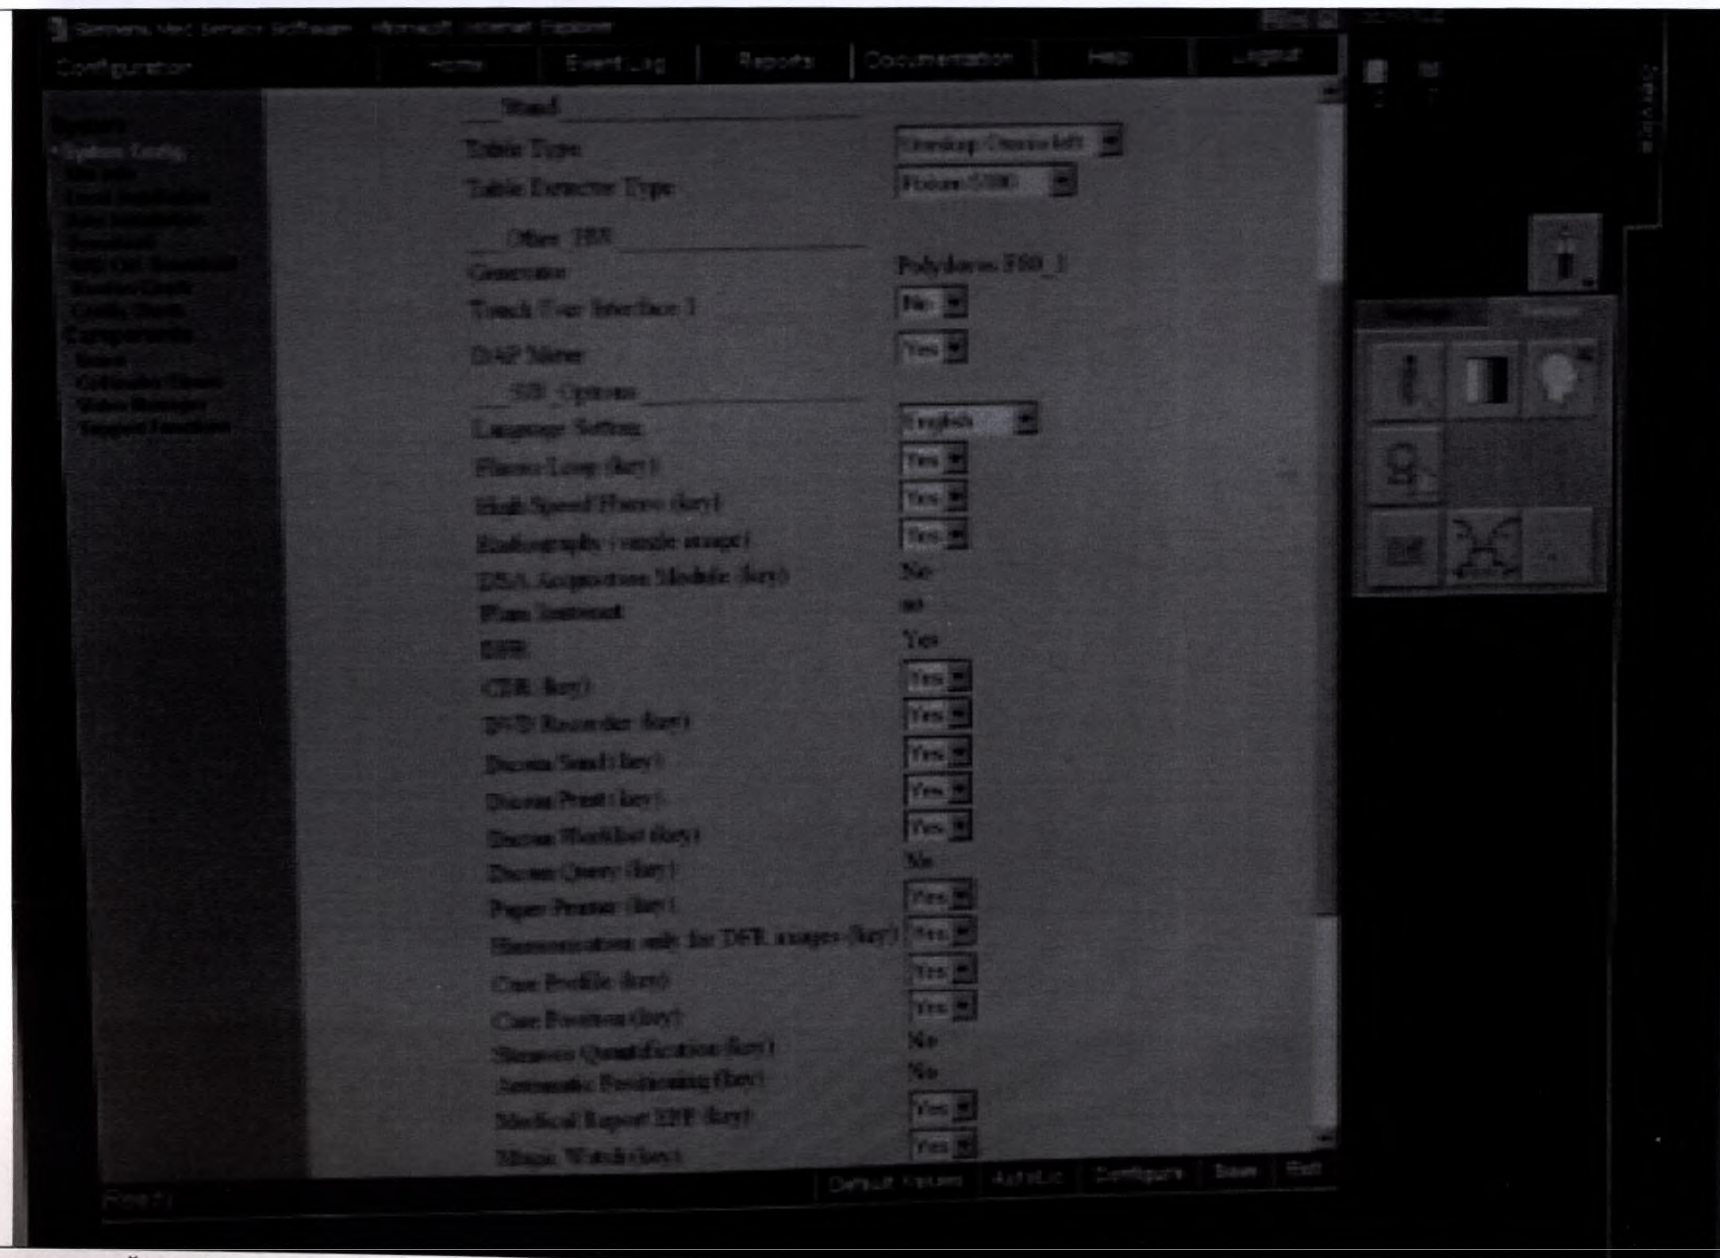


32. Лицензионный ключ для сохранения эндоскопических изображений HD EndoStore

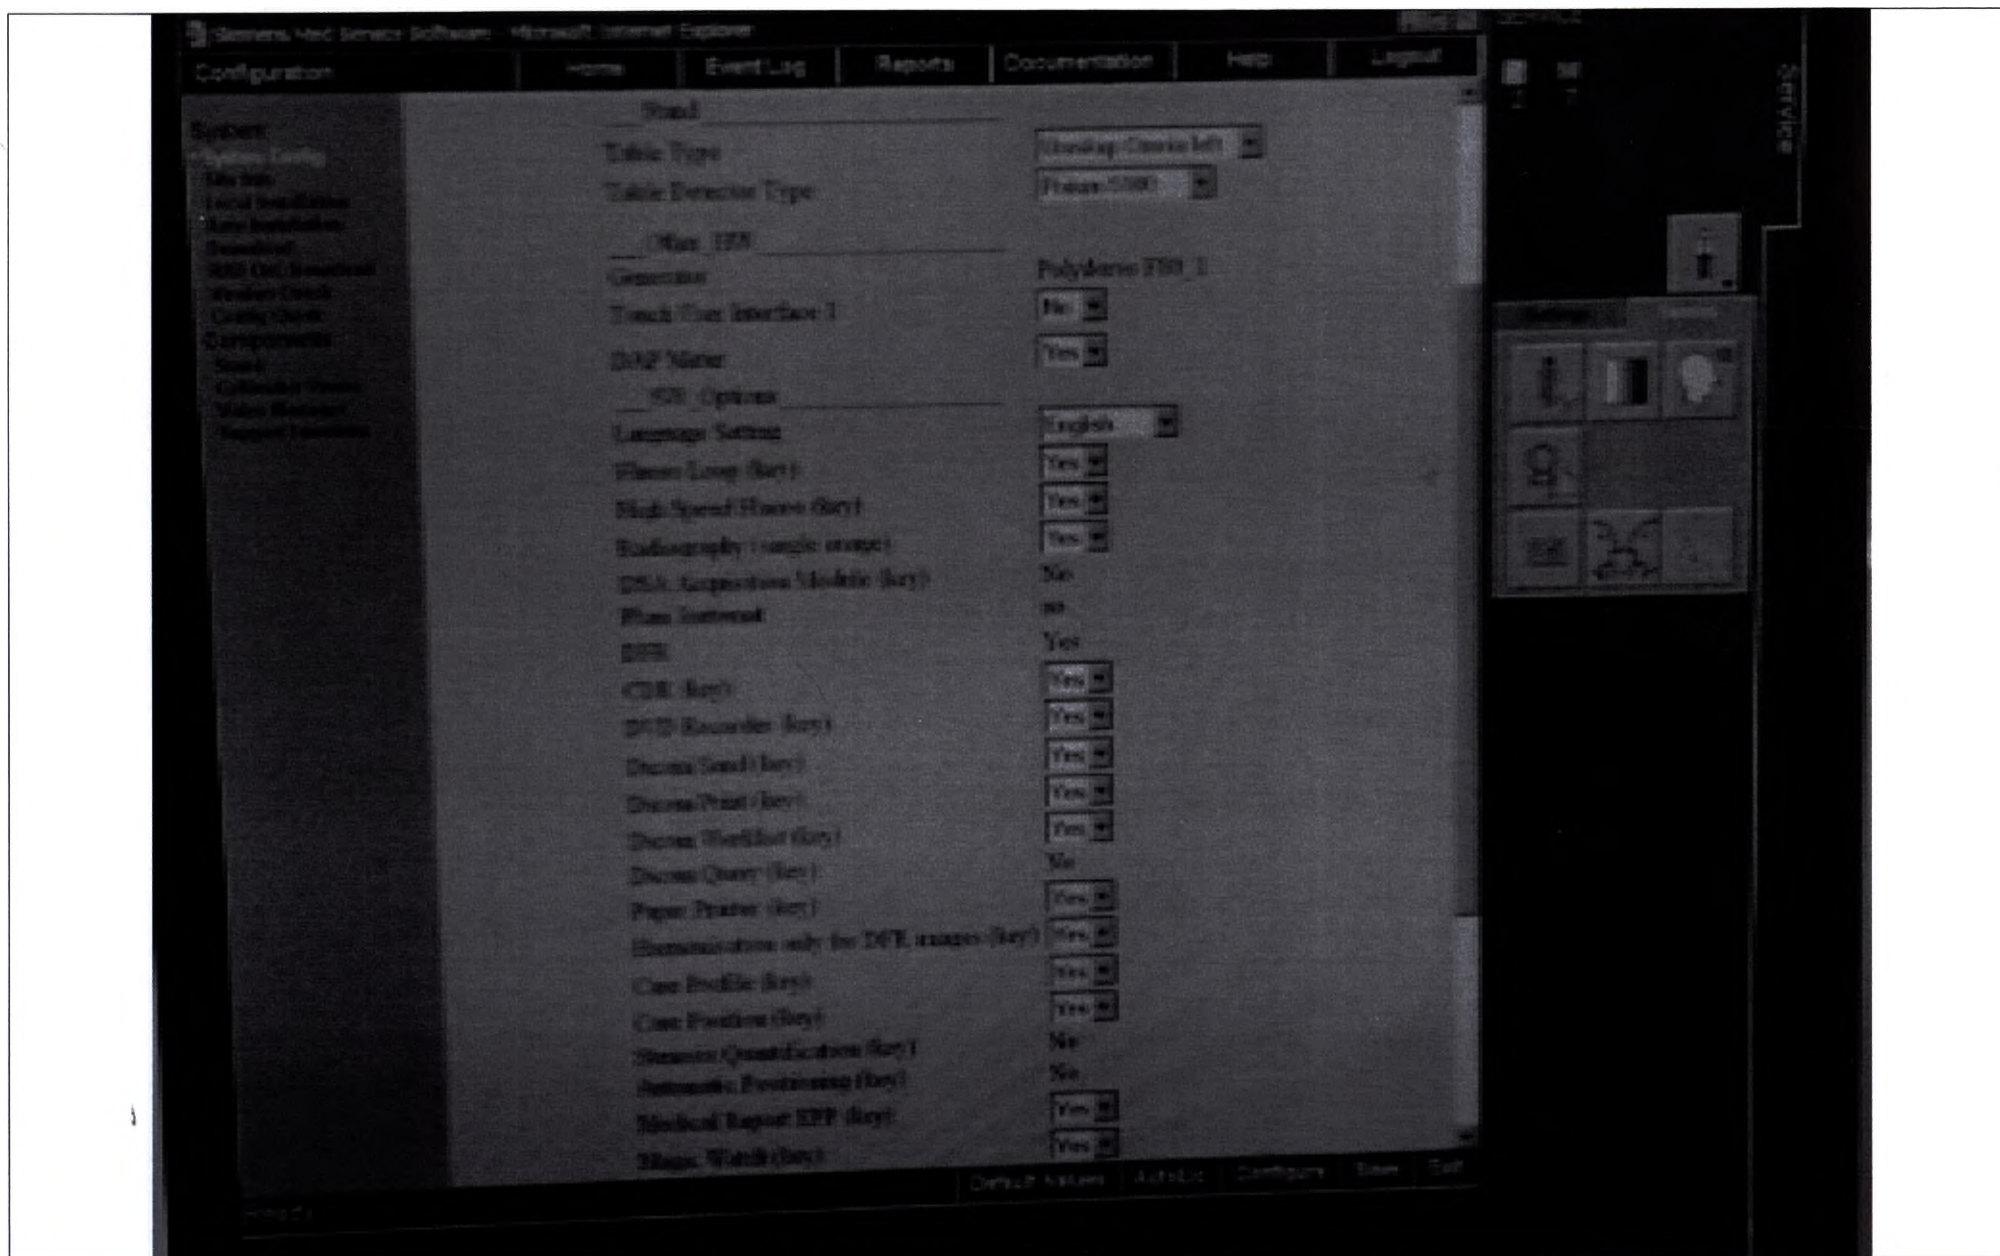


33. Лицензионный ключ для виртуальной коллимации CAREPROFILE

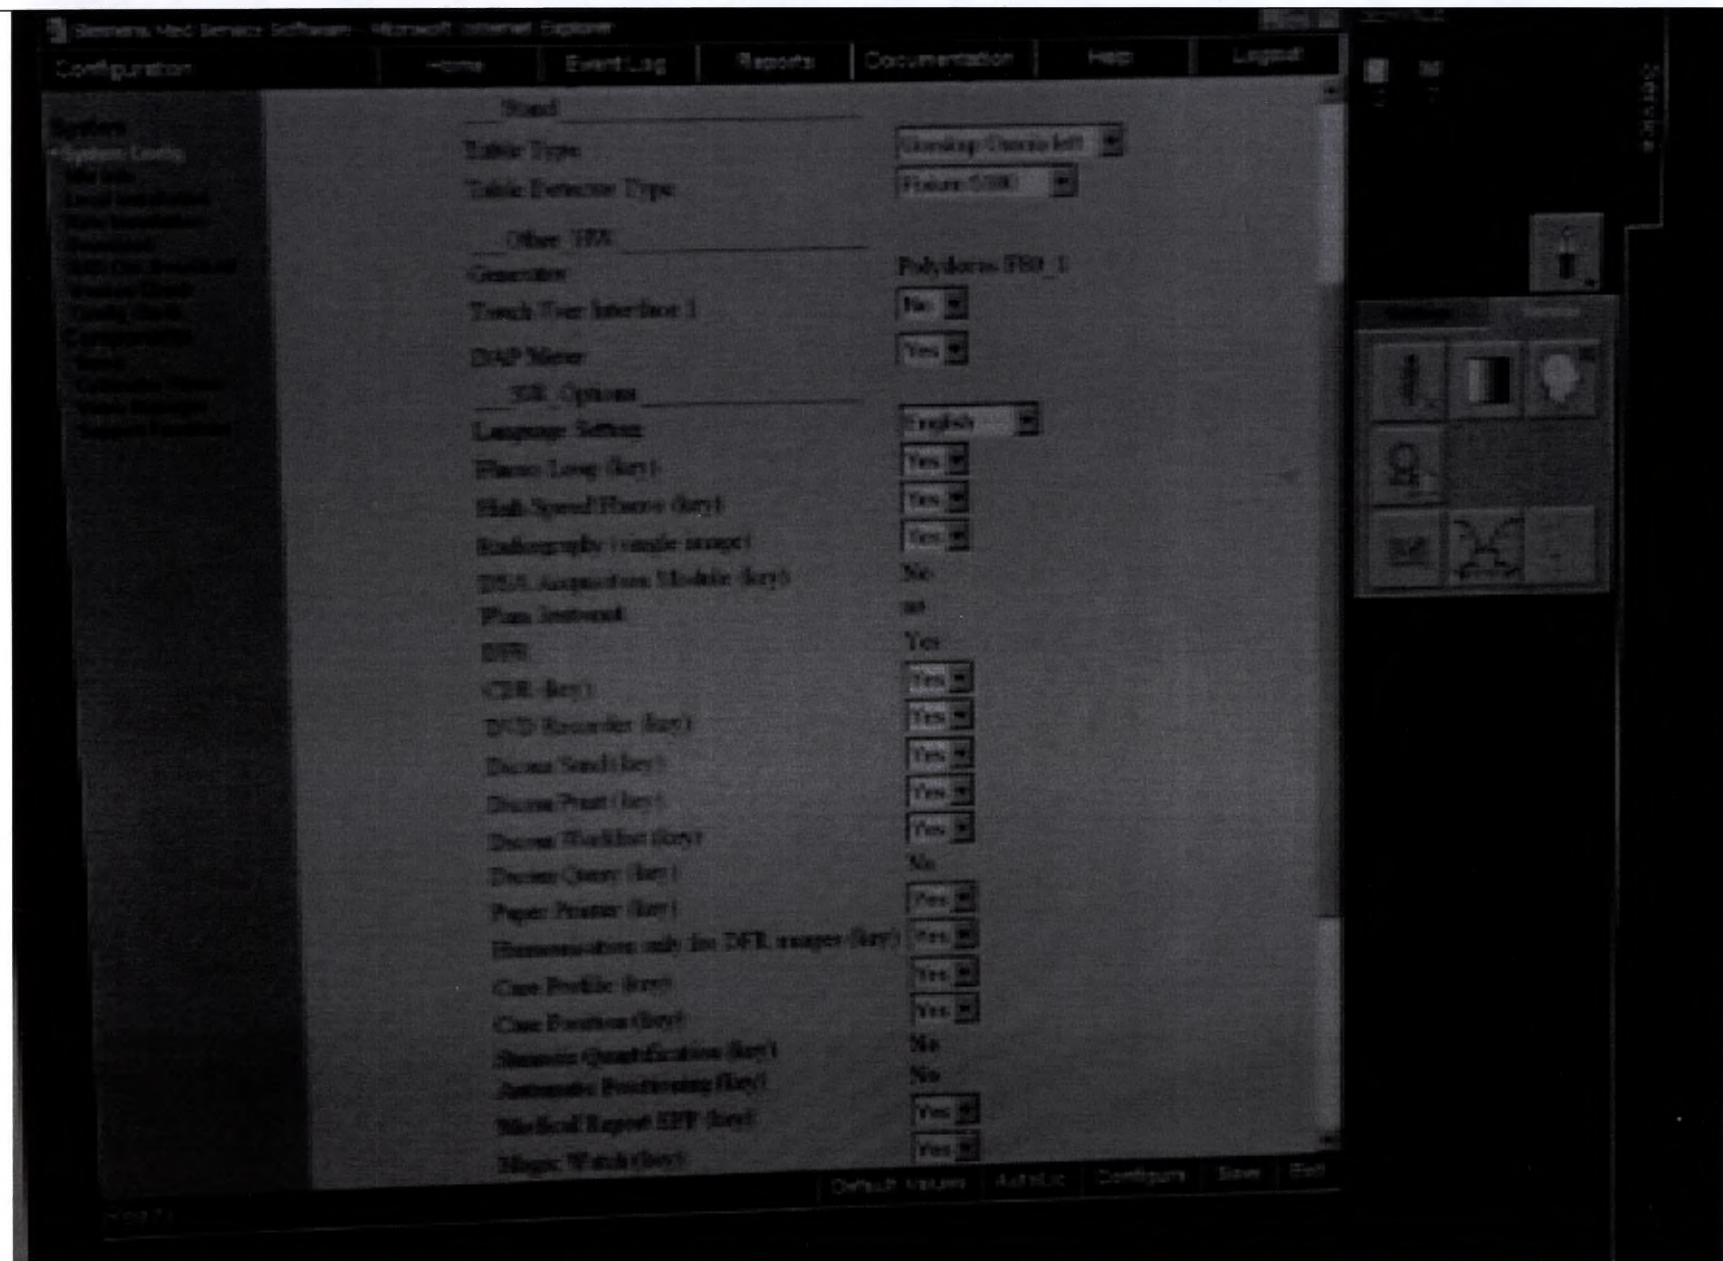

34. Лицензионный ключ для позиционирования CAREPOSITION

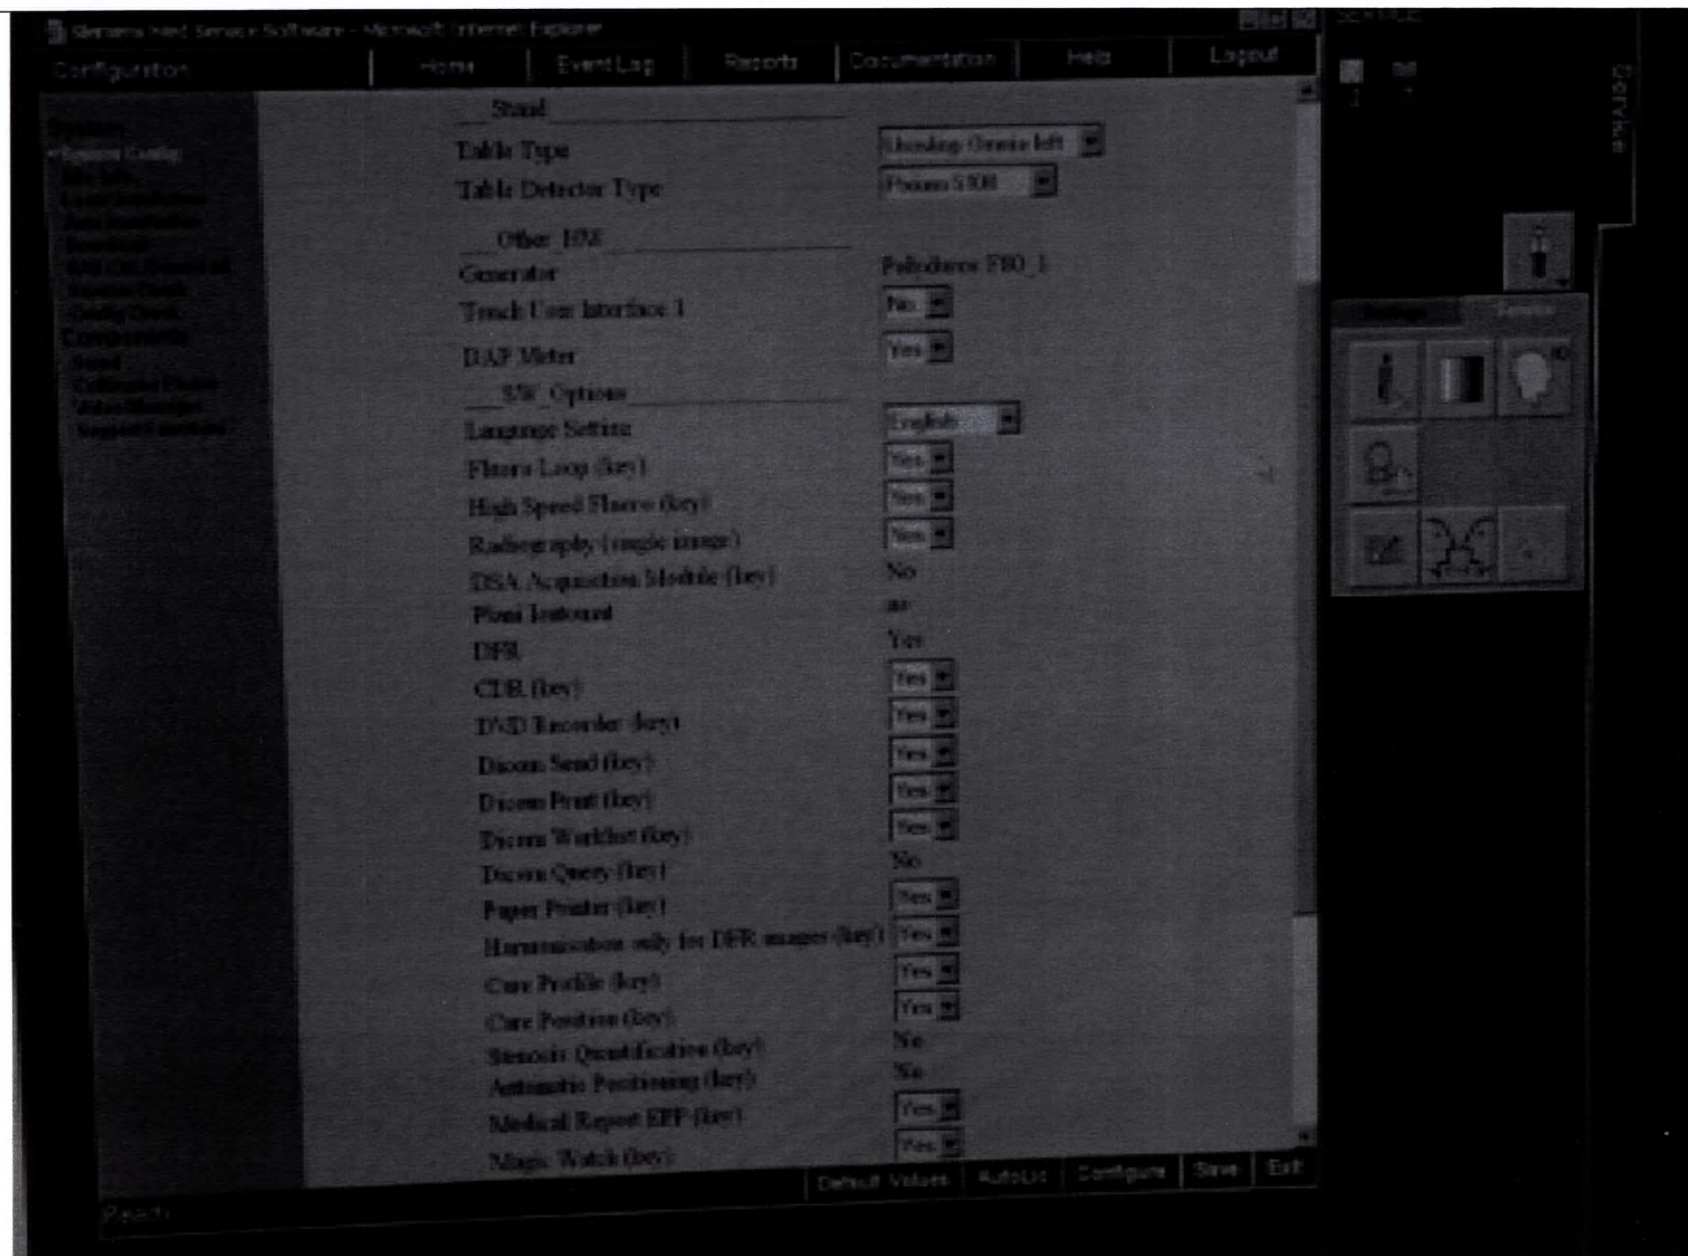


36. Лицензионный ключ для компенсации разницы плотности тканей (Гармонизация).

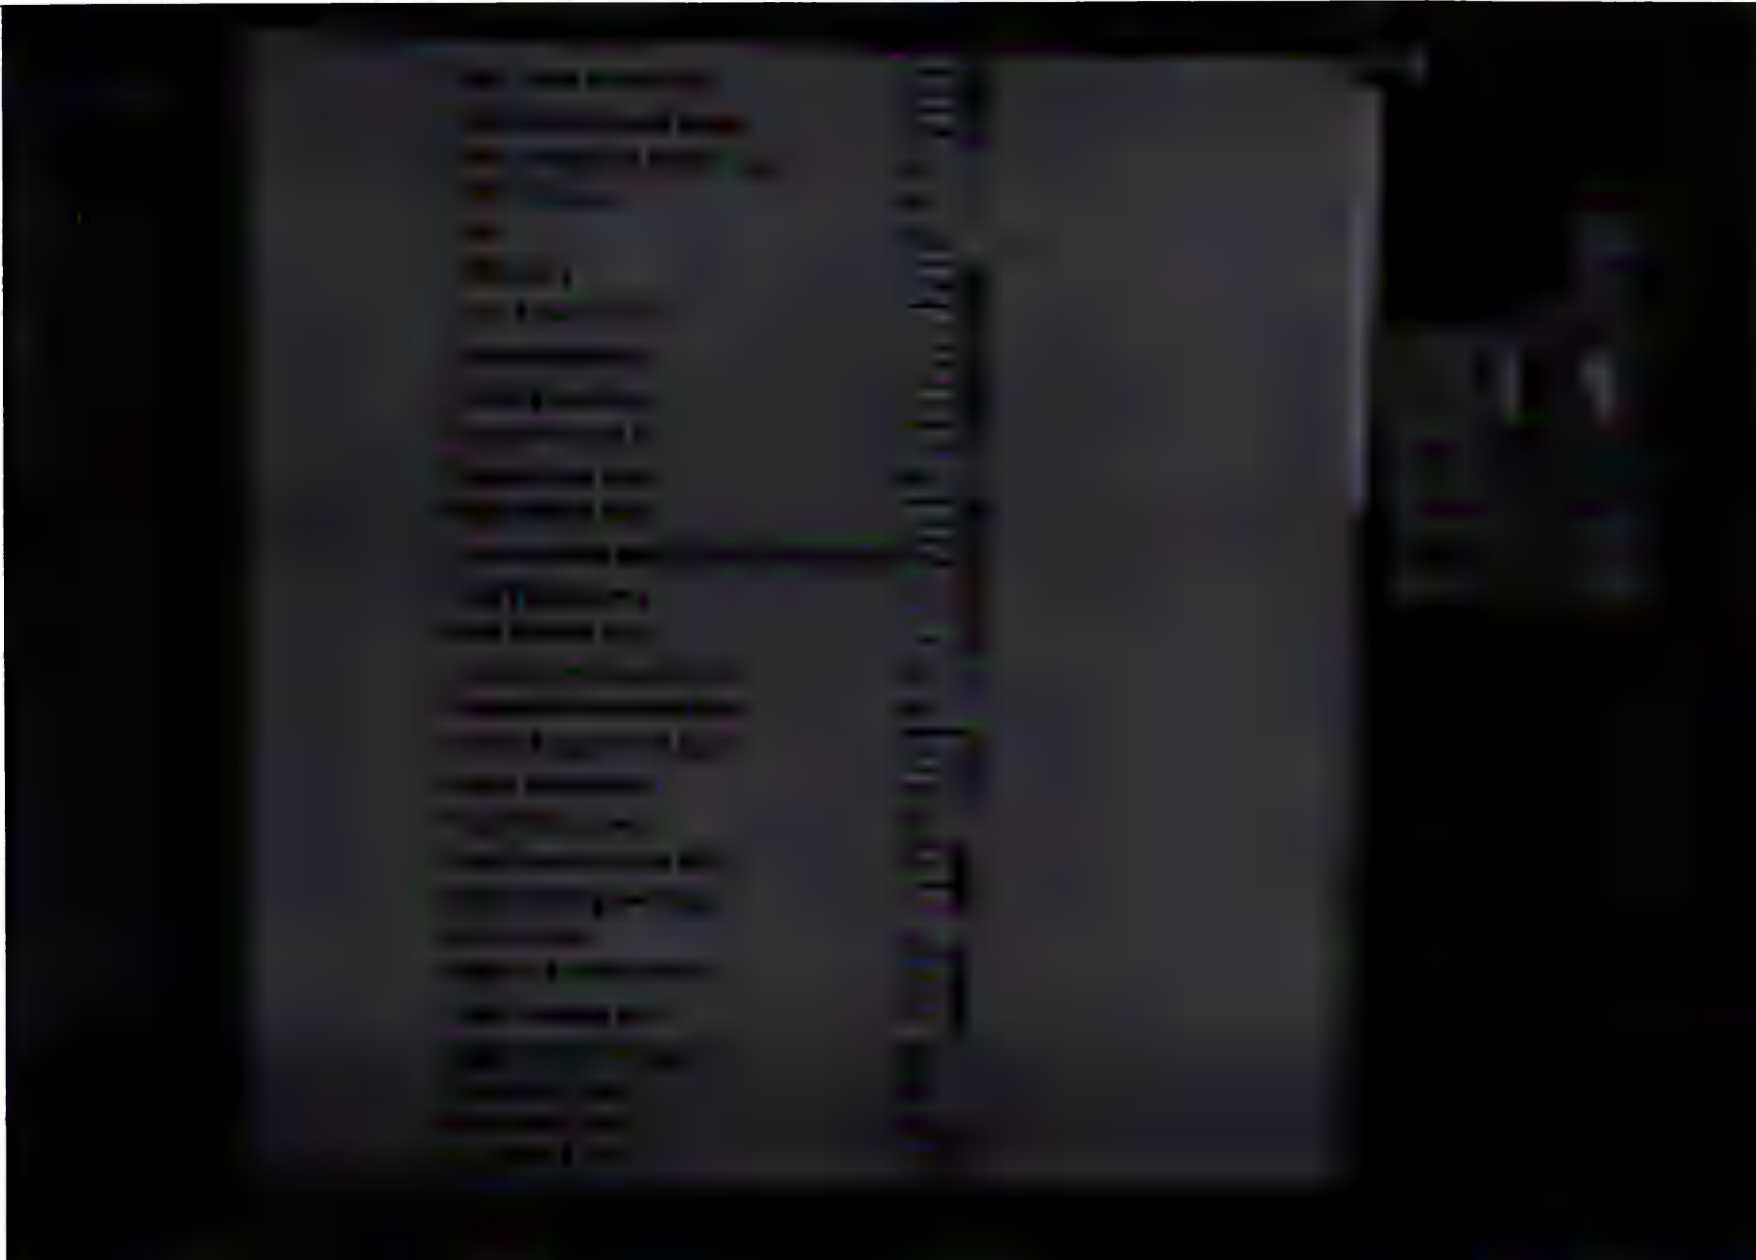


37. Лицензионный ключ DICOM Query/Retrieve.



38. Лицензионный ключ для связи с информационной сетью госпиталя DICOM Worklist/MPPS.

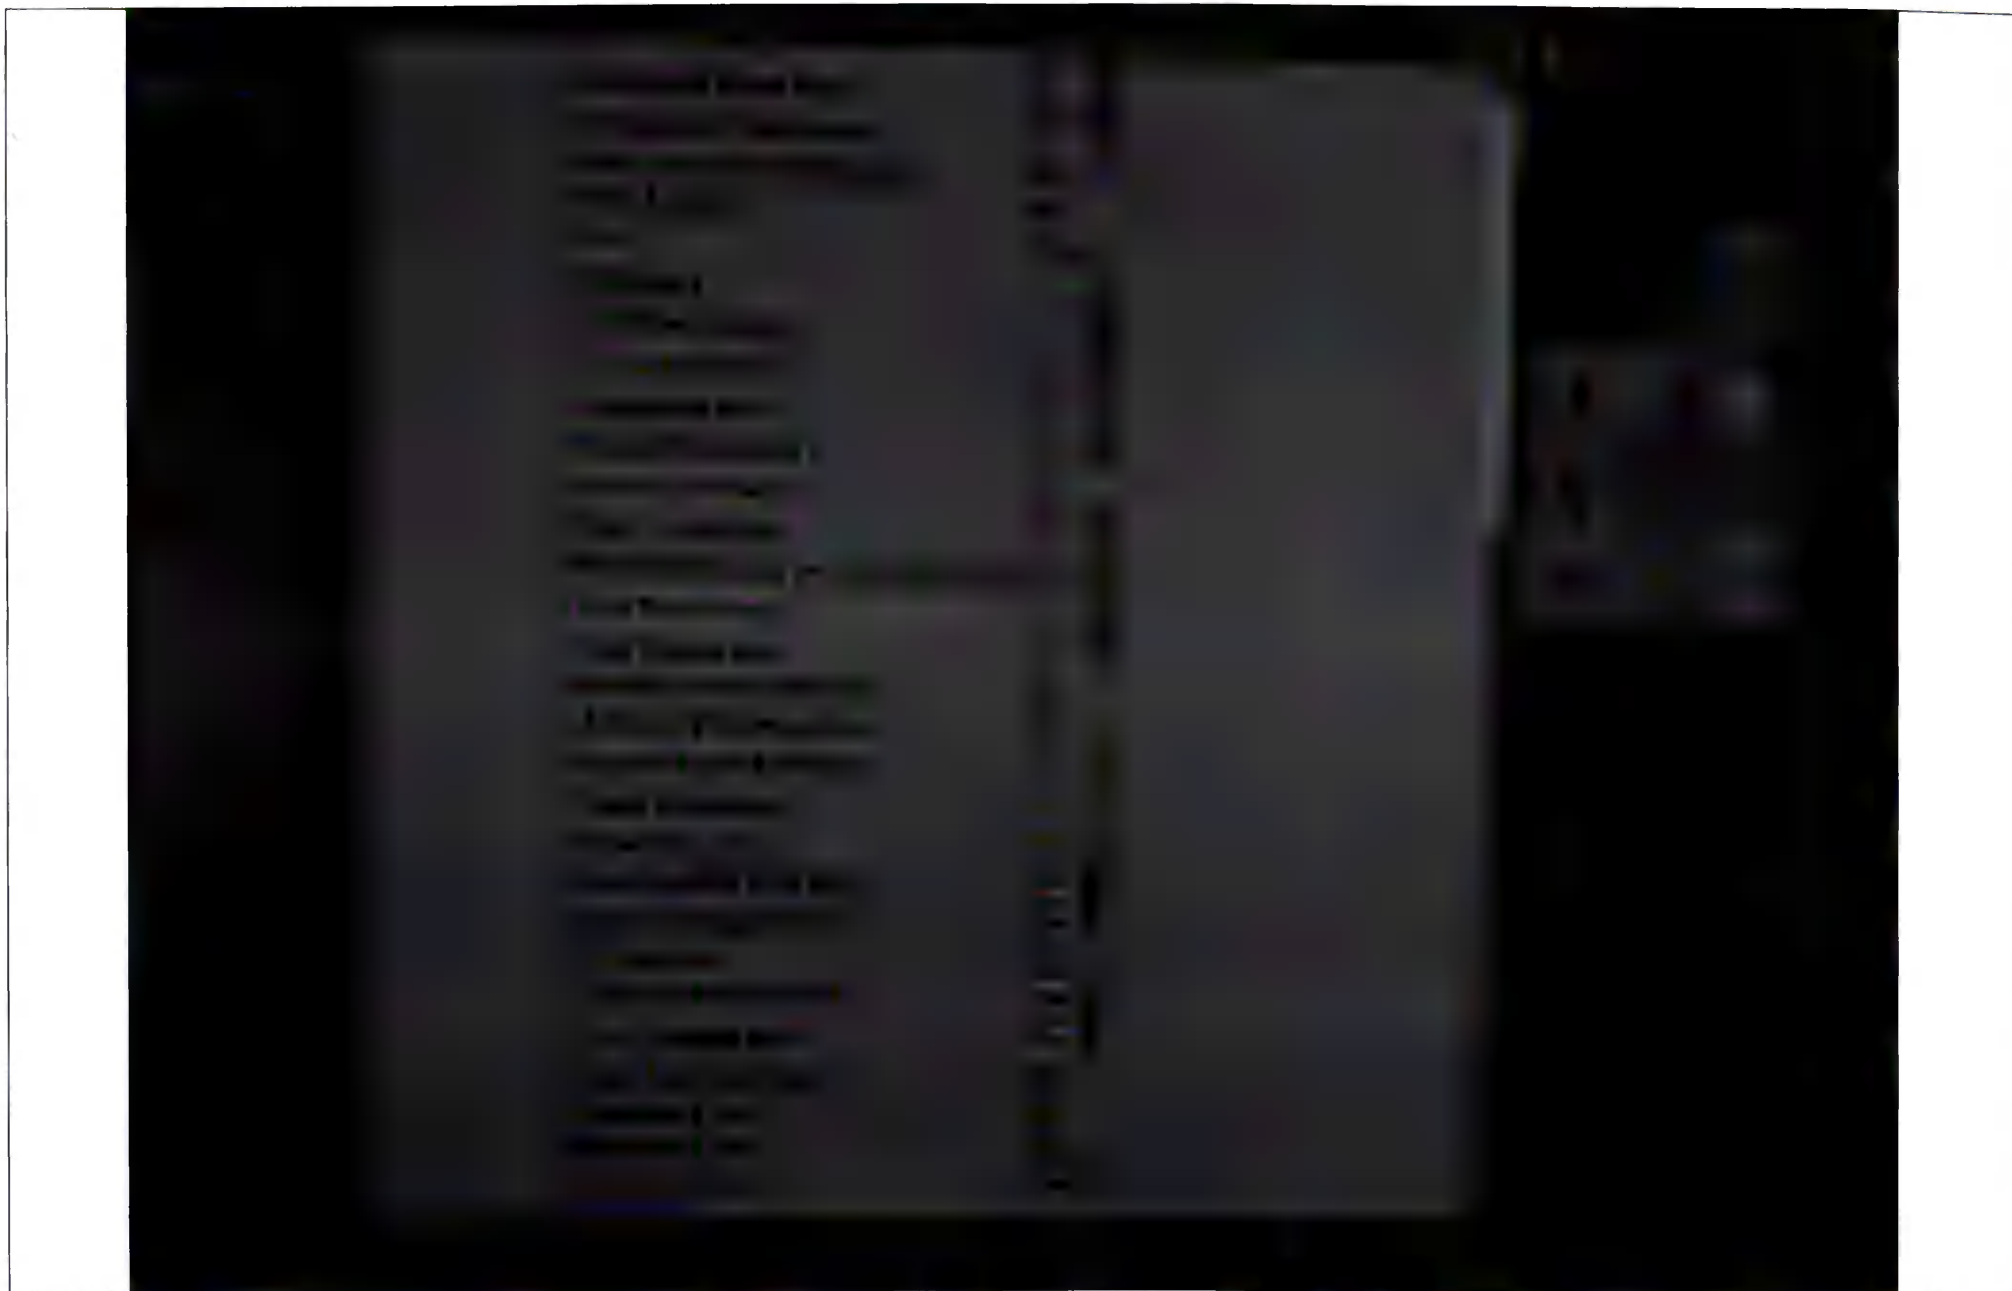


39. Лицензионный ключ для печати изображений стандарта DICOM Print.

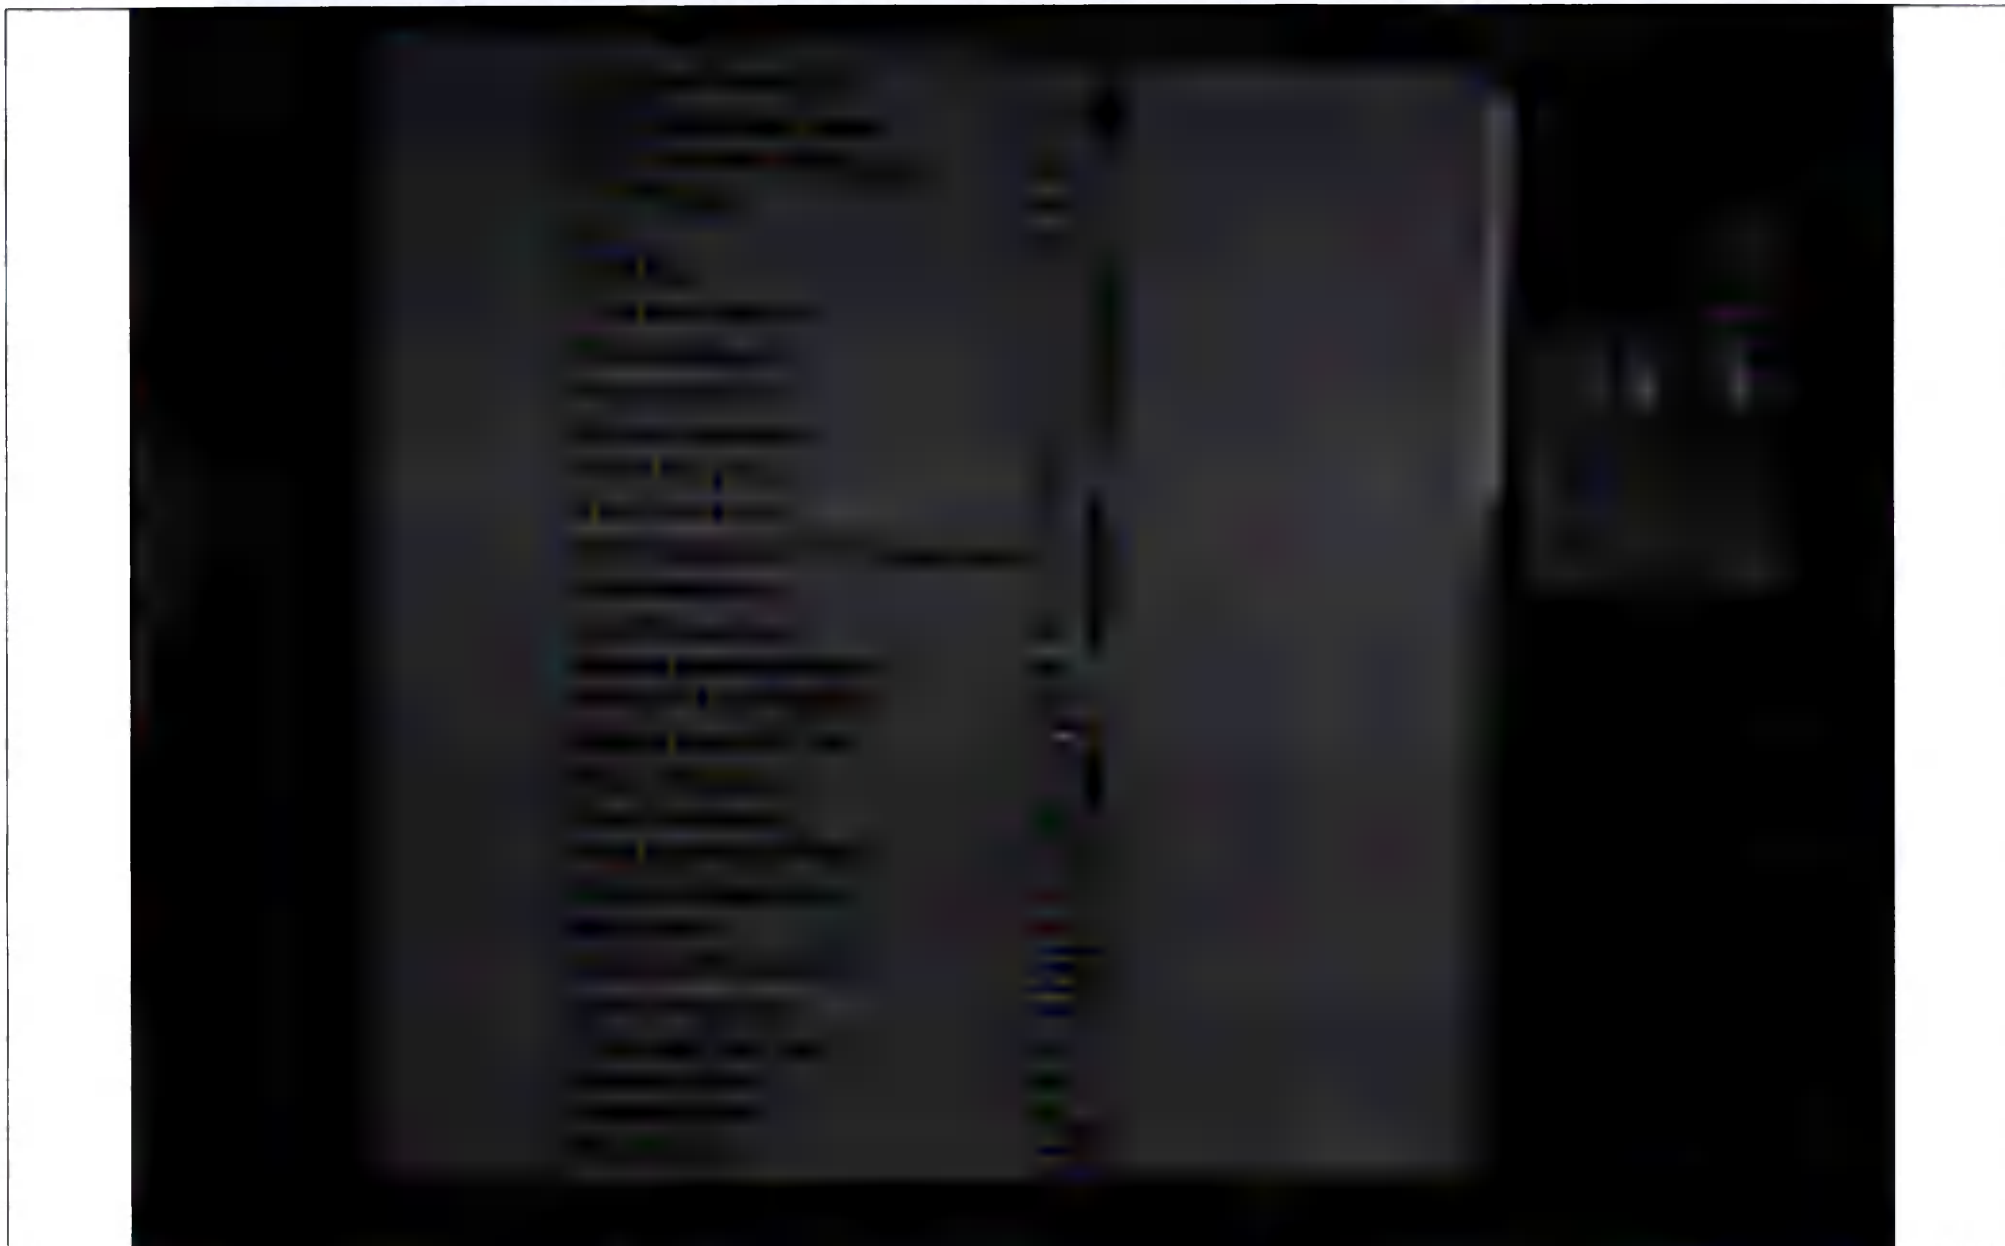

40. Лицензионный ключ для просмотра изображений других модальностей Multi Modality Viewing.




41. Интерфейс для подключения DVD

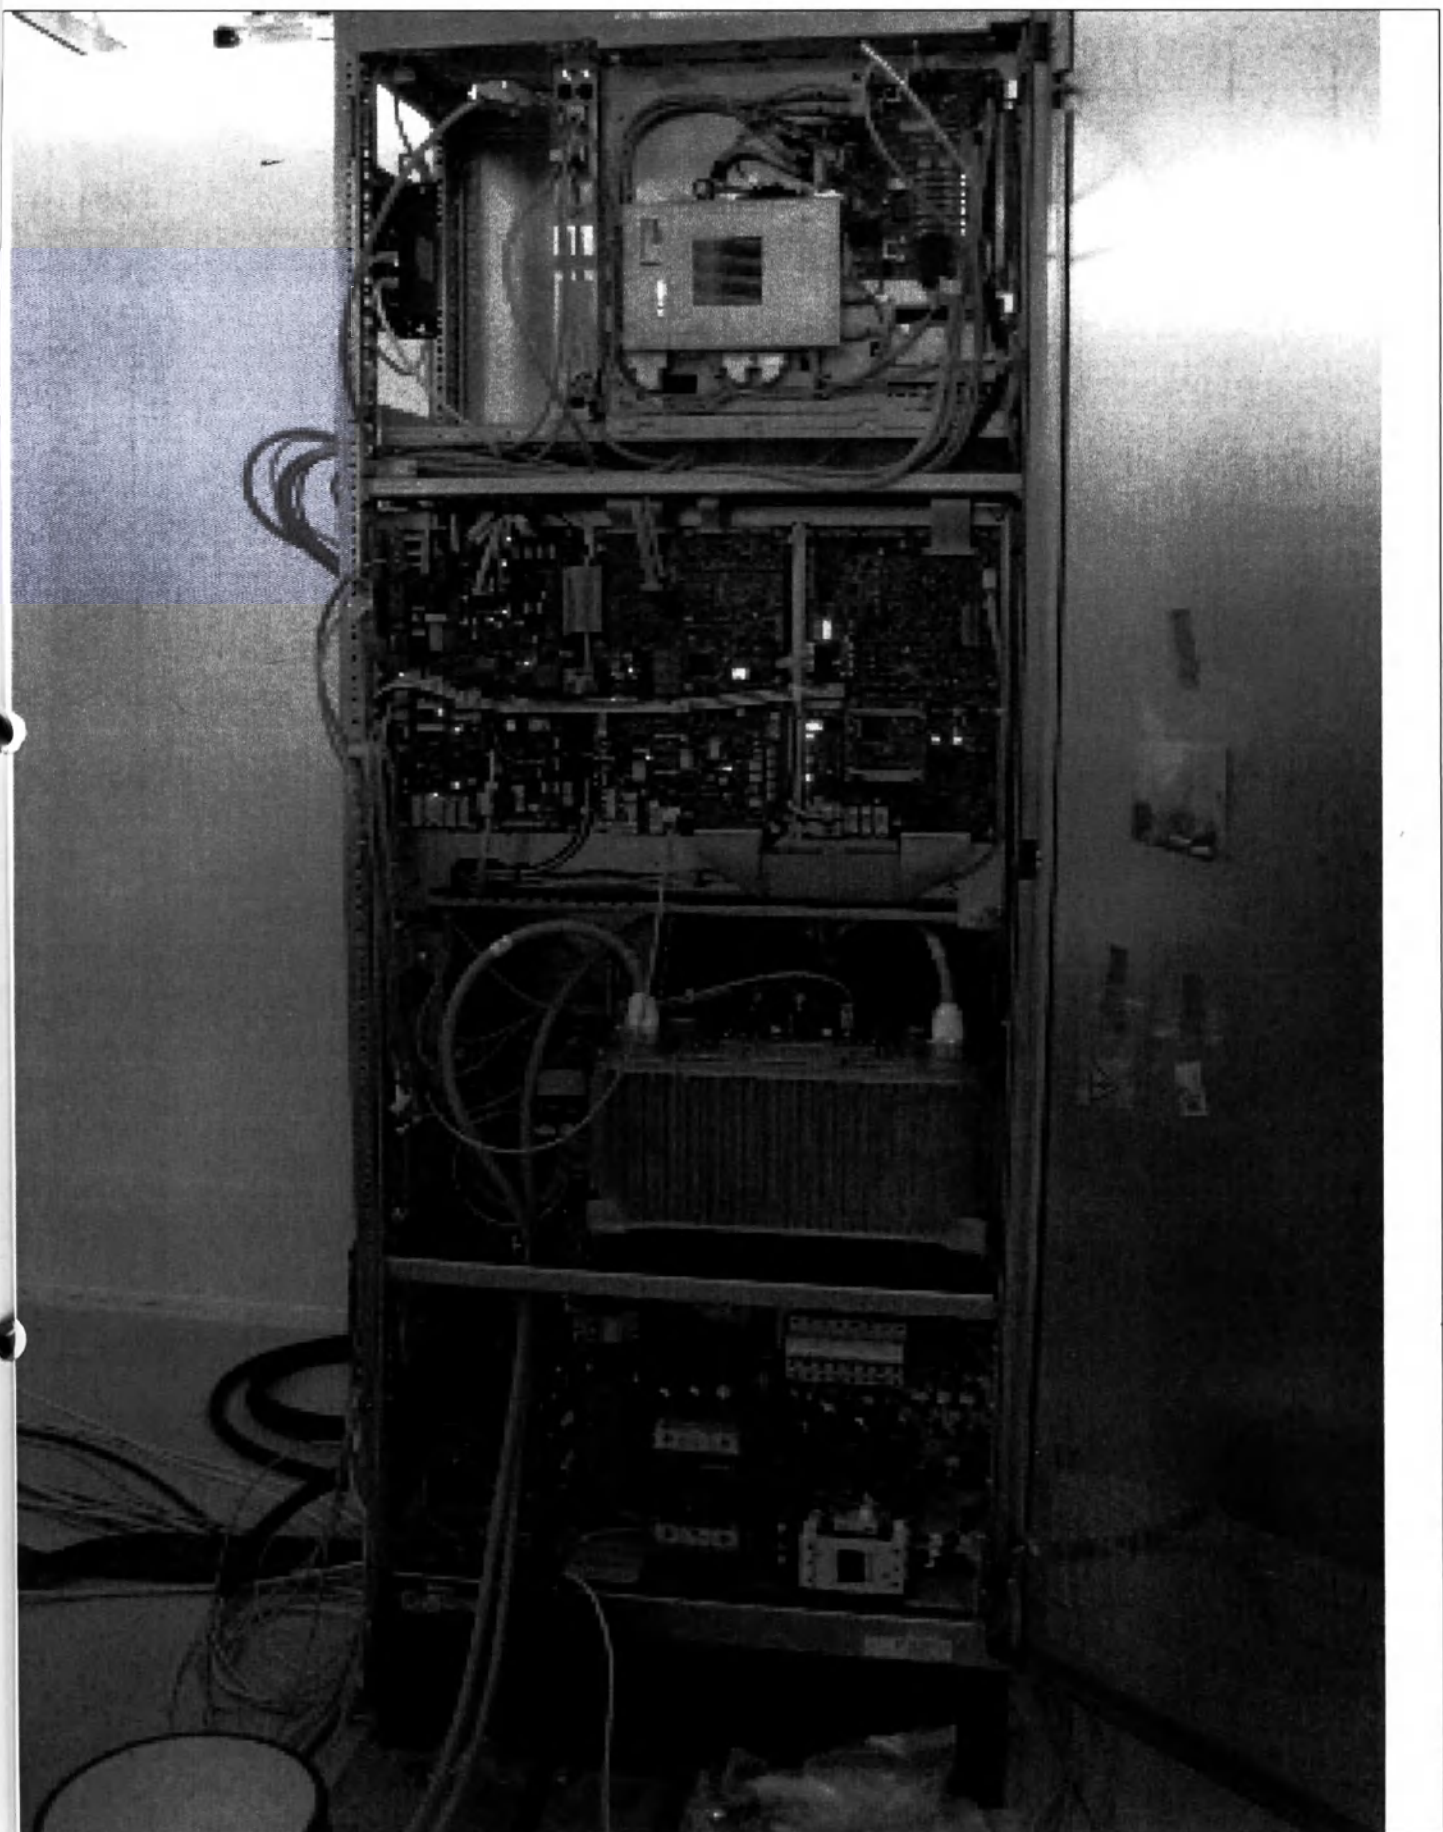

42. Опция увеличения мощности генератора POLYDOROS F65 до 80 кВт


Material	14460026	Advanced Security Package	
Branche	M	Maschinenbau	
Materialart	VBLO	Vertriebsblock	
DispoStufe	001		
Erstanlage durch	ASLAFAP5	am	10.10.17
letzte Änderung	HEINSUG6	am	01.07.19

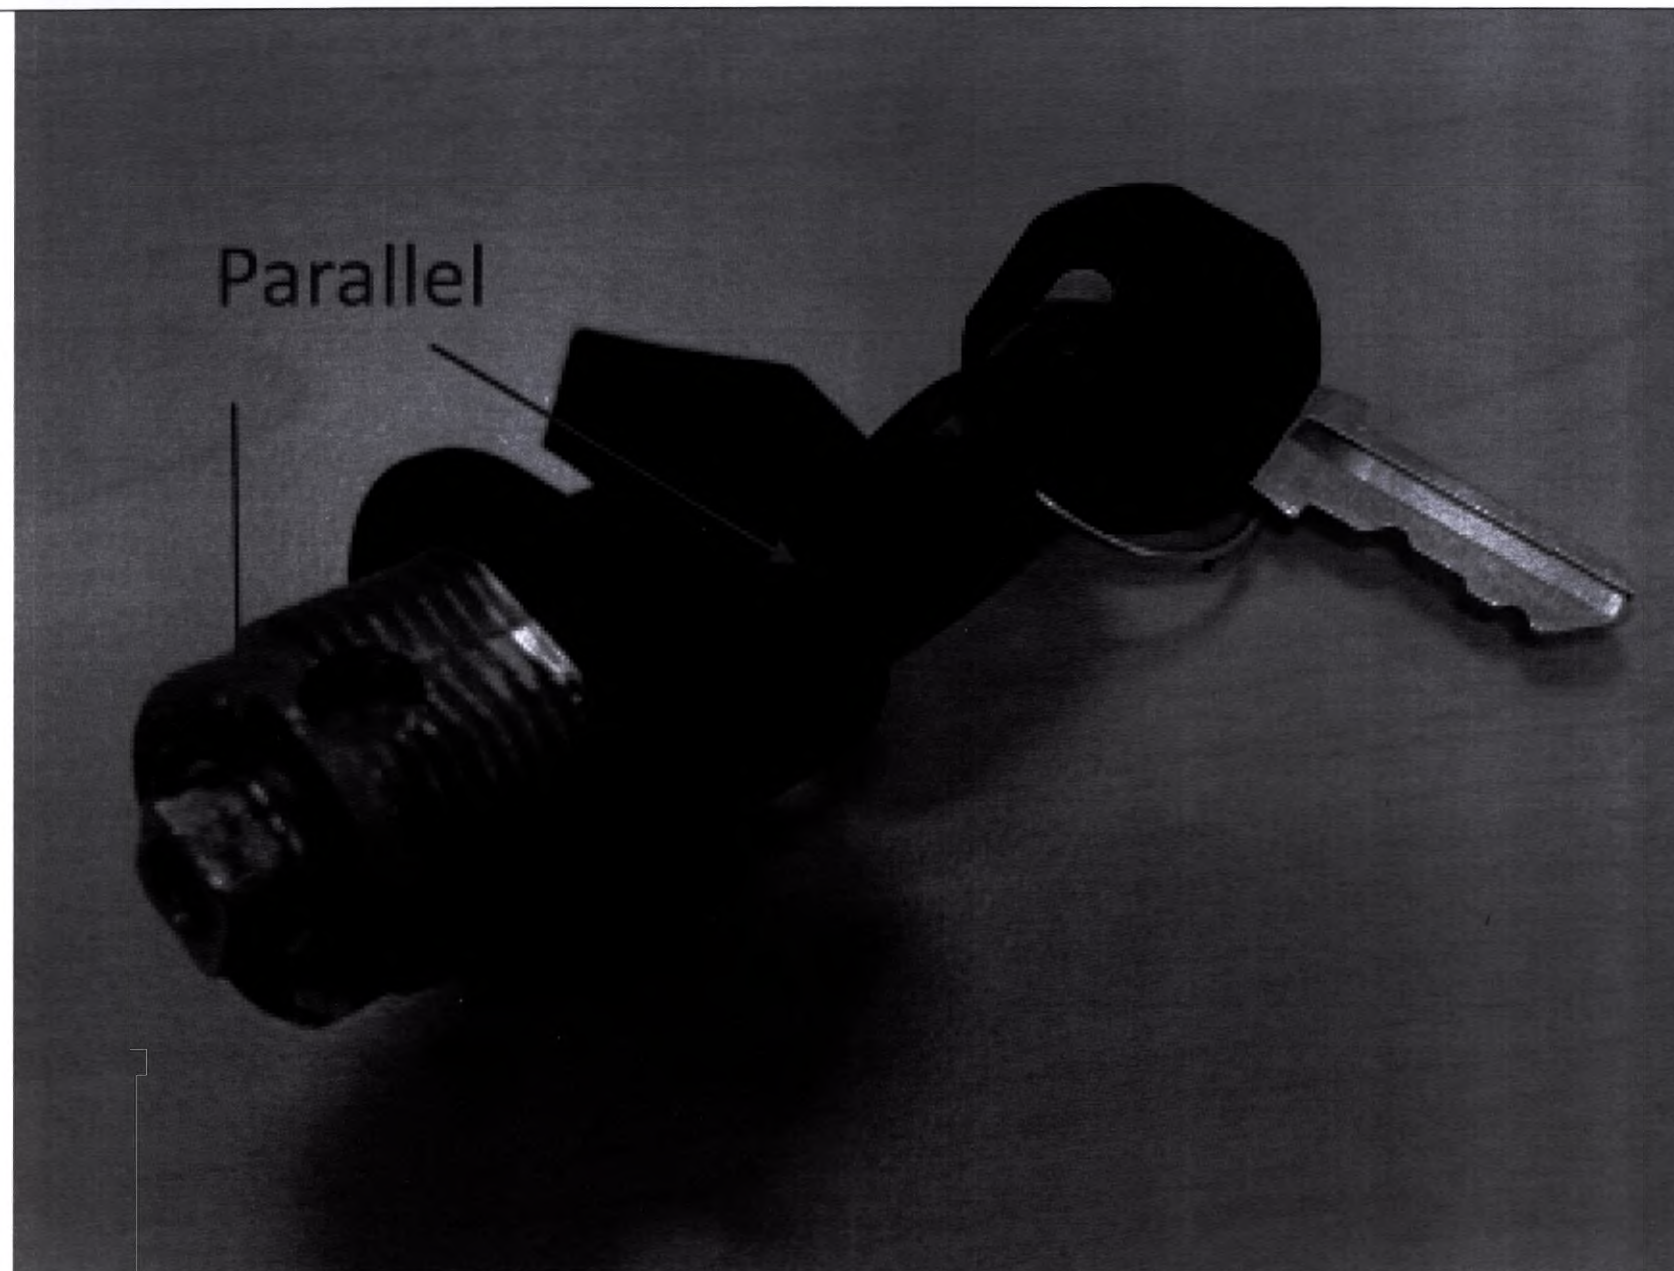


44. Пакет аппаратной защиты

Material	14460028	Virtual Workstation	
Branche	M	Maschinenbau	
Materialart	VBLO	Vertriebsblock	
DispoStufe	001		
Erstanlage durch	ASLAFAP5	am	12.10.17
letzte Änderung	HEINSUG6	am	01.07.19

45. Лицензионный ключ виртуальной рабочей станции

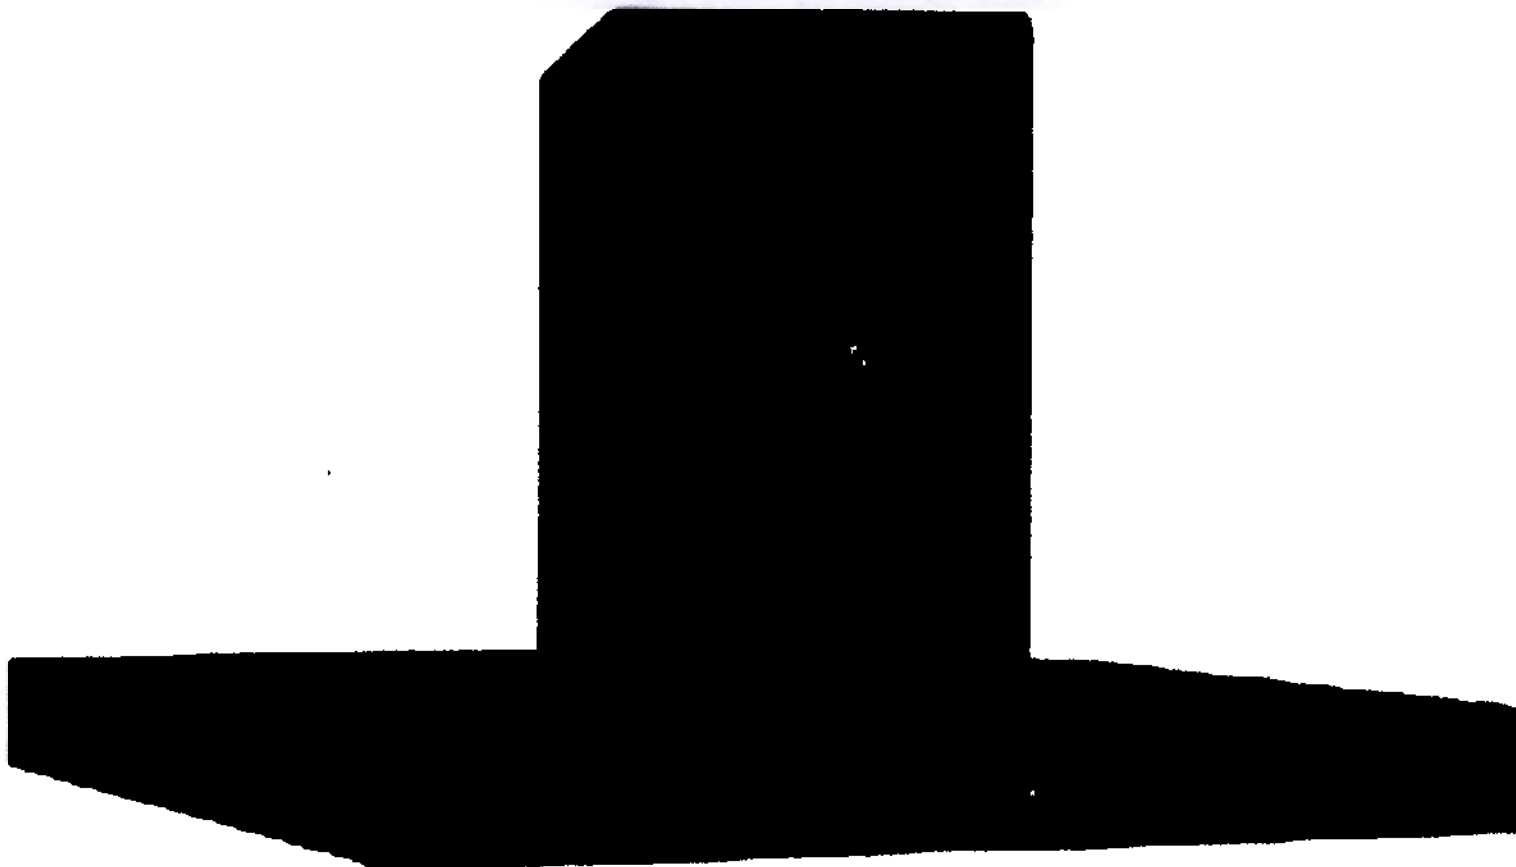

47. Источник бесперебойного питания для станции формирования изображений.

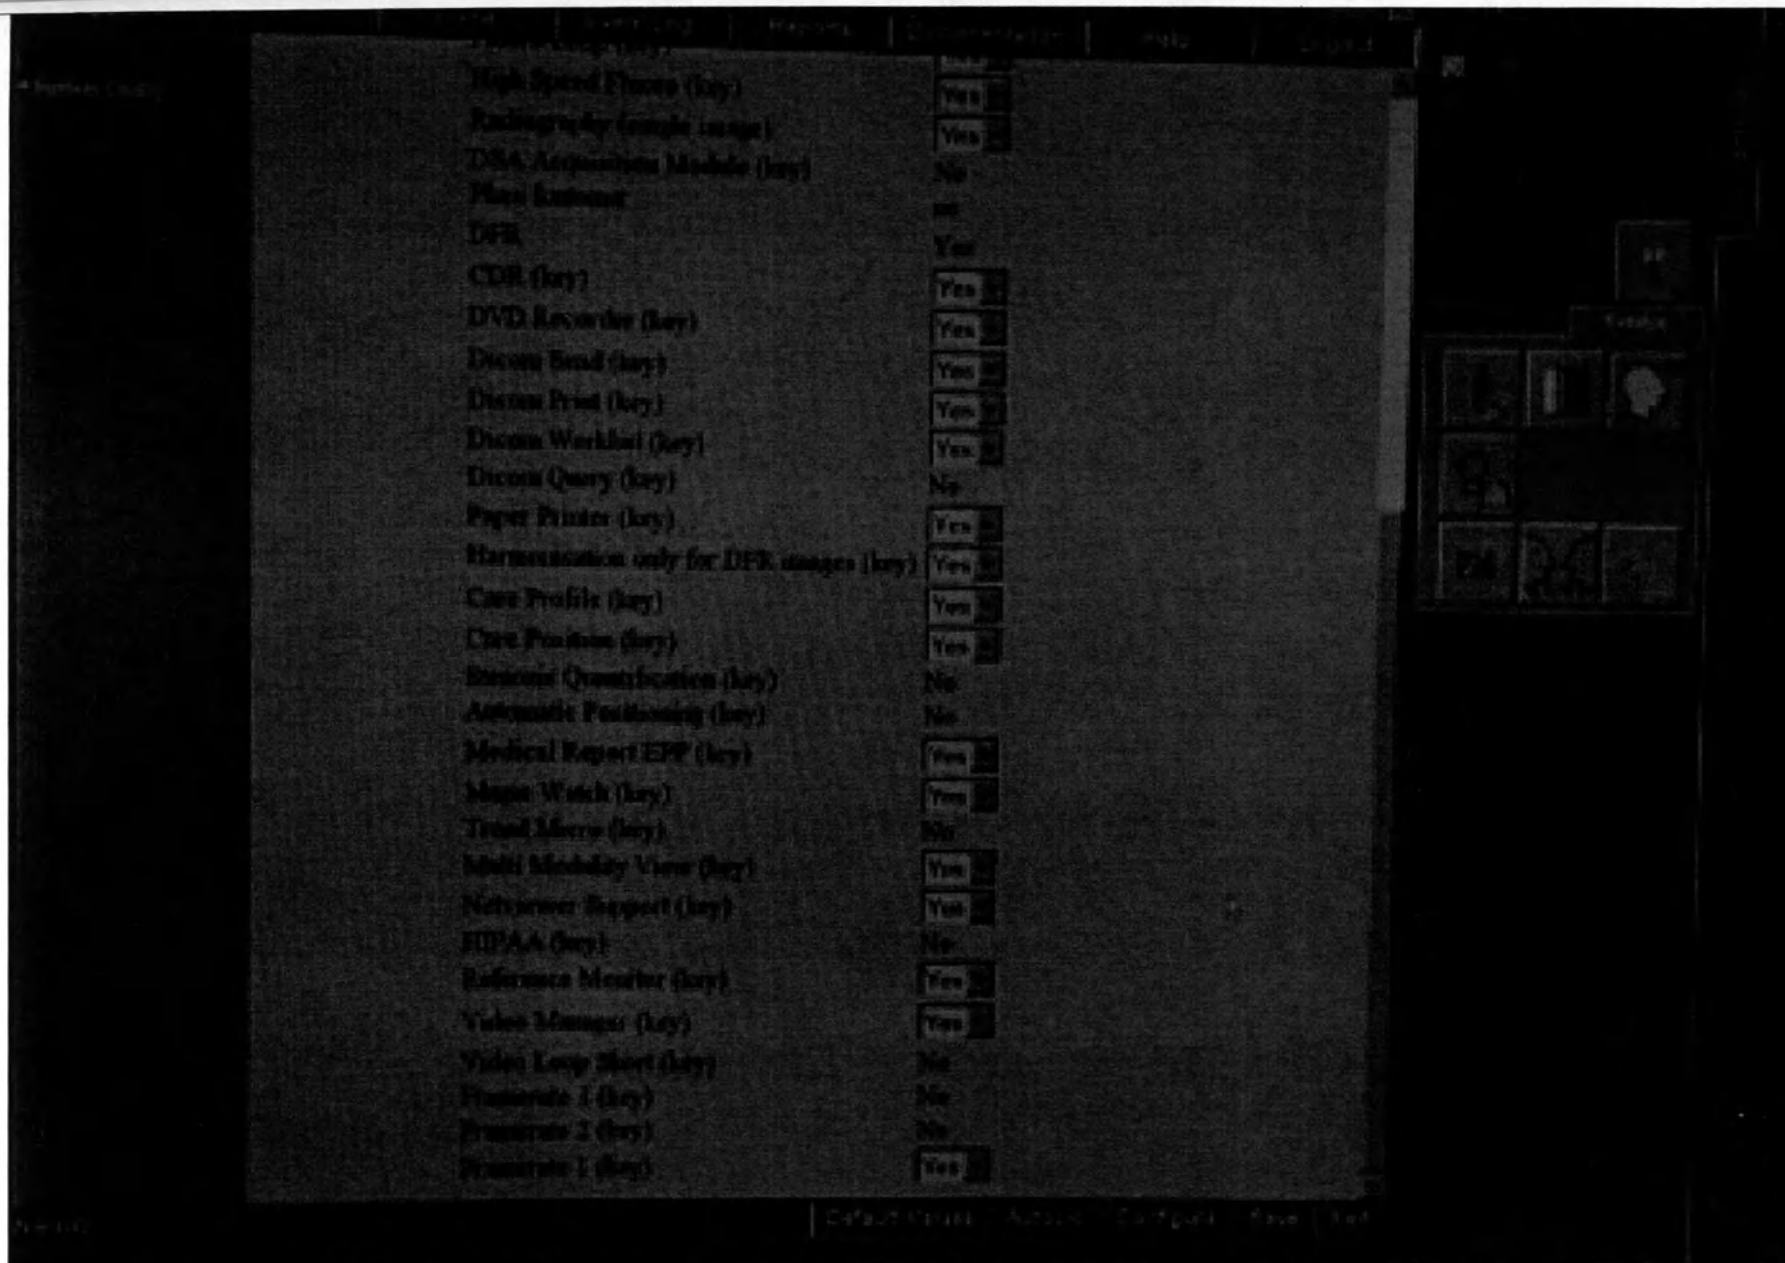

46. Лицензионный ключ Enhanced CARE Package

Всего прошито и пронумеровано
34 листа (ов).

ООО «Сименс Здравоохранение»

