Протезы кровеносных сосудов ePTFE Vascular Graft

Venaflo II WITH CARBON STEPPED

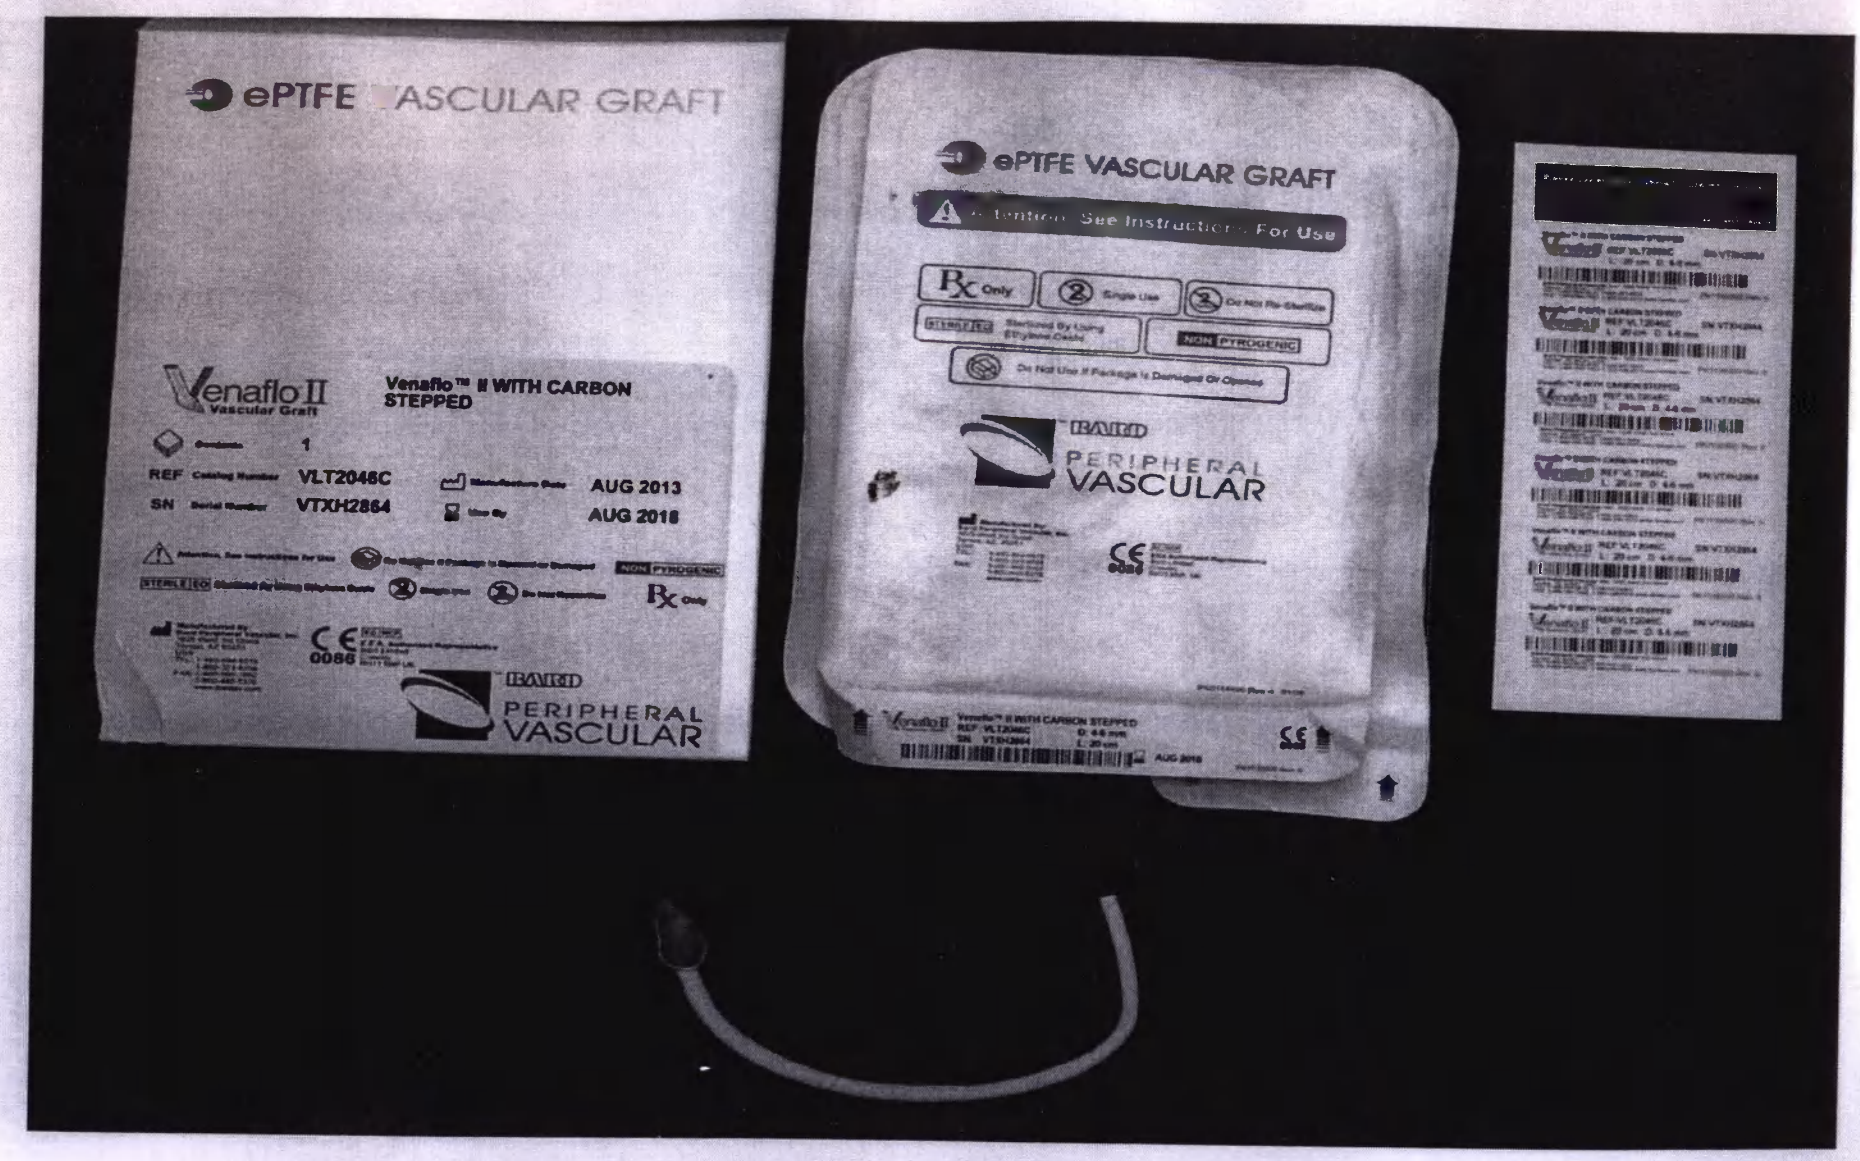

ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

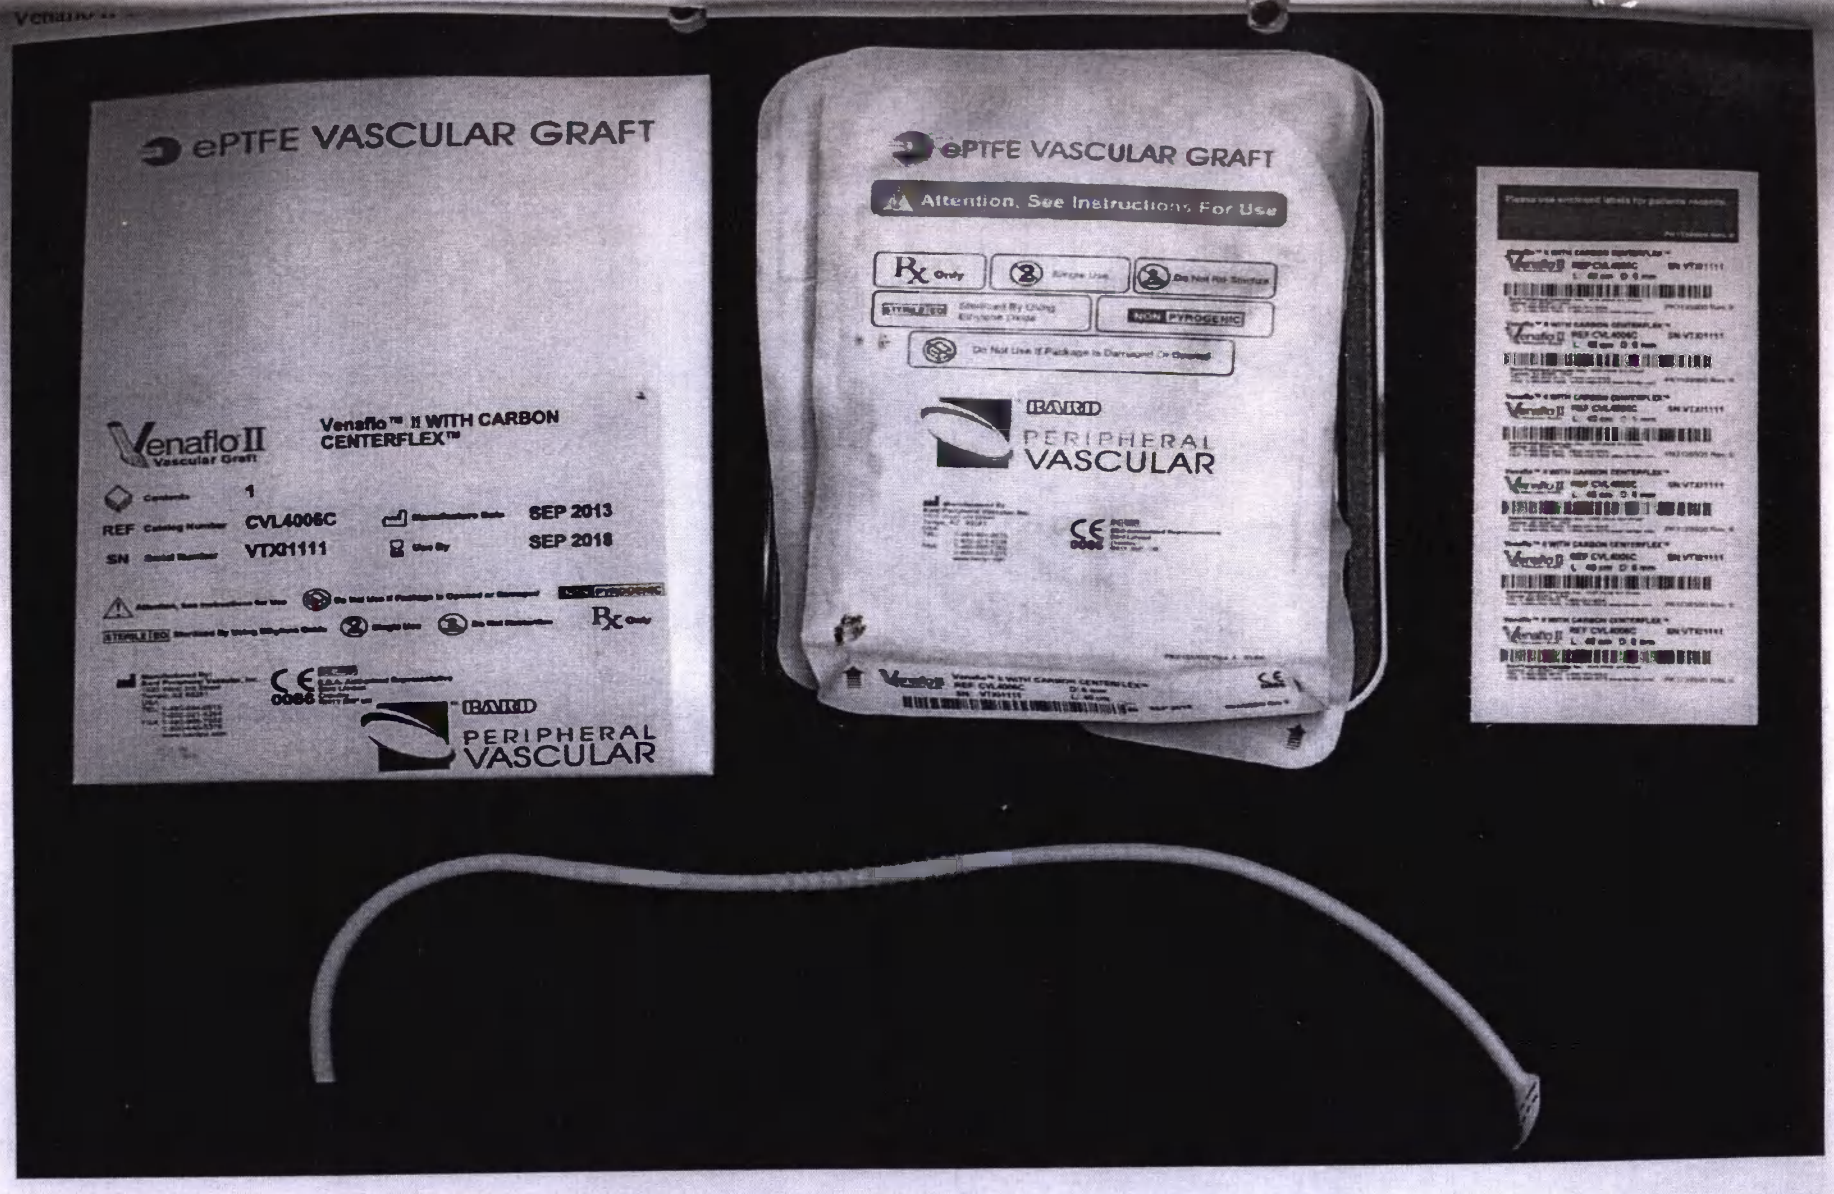

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

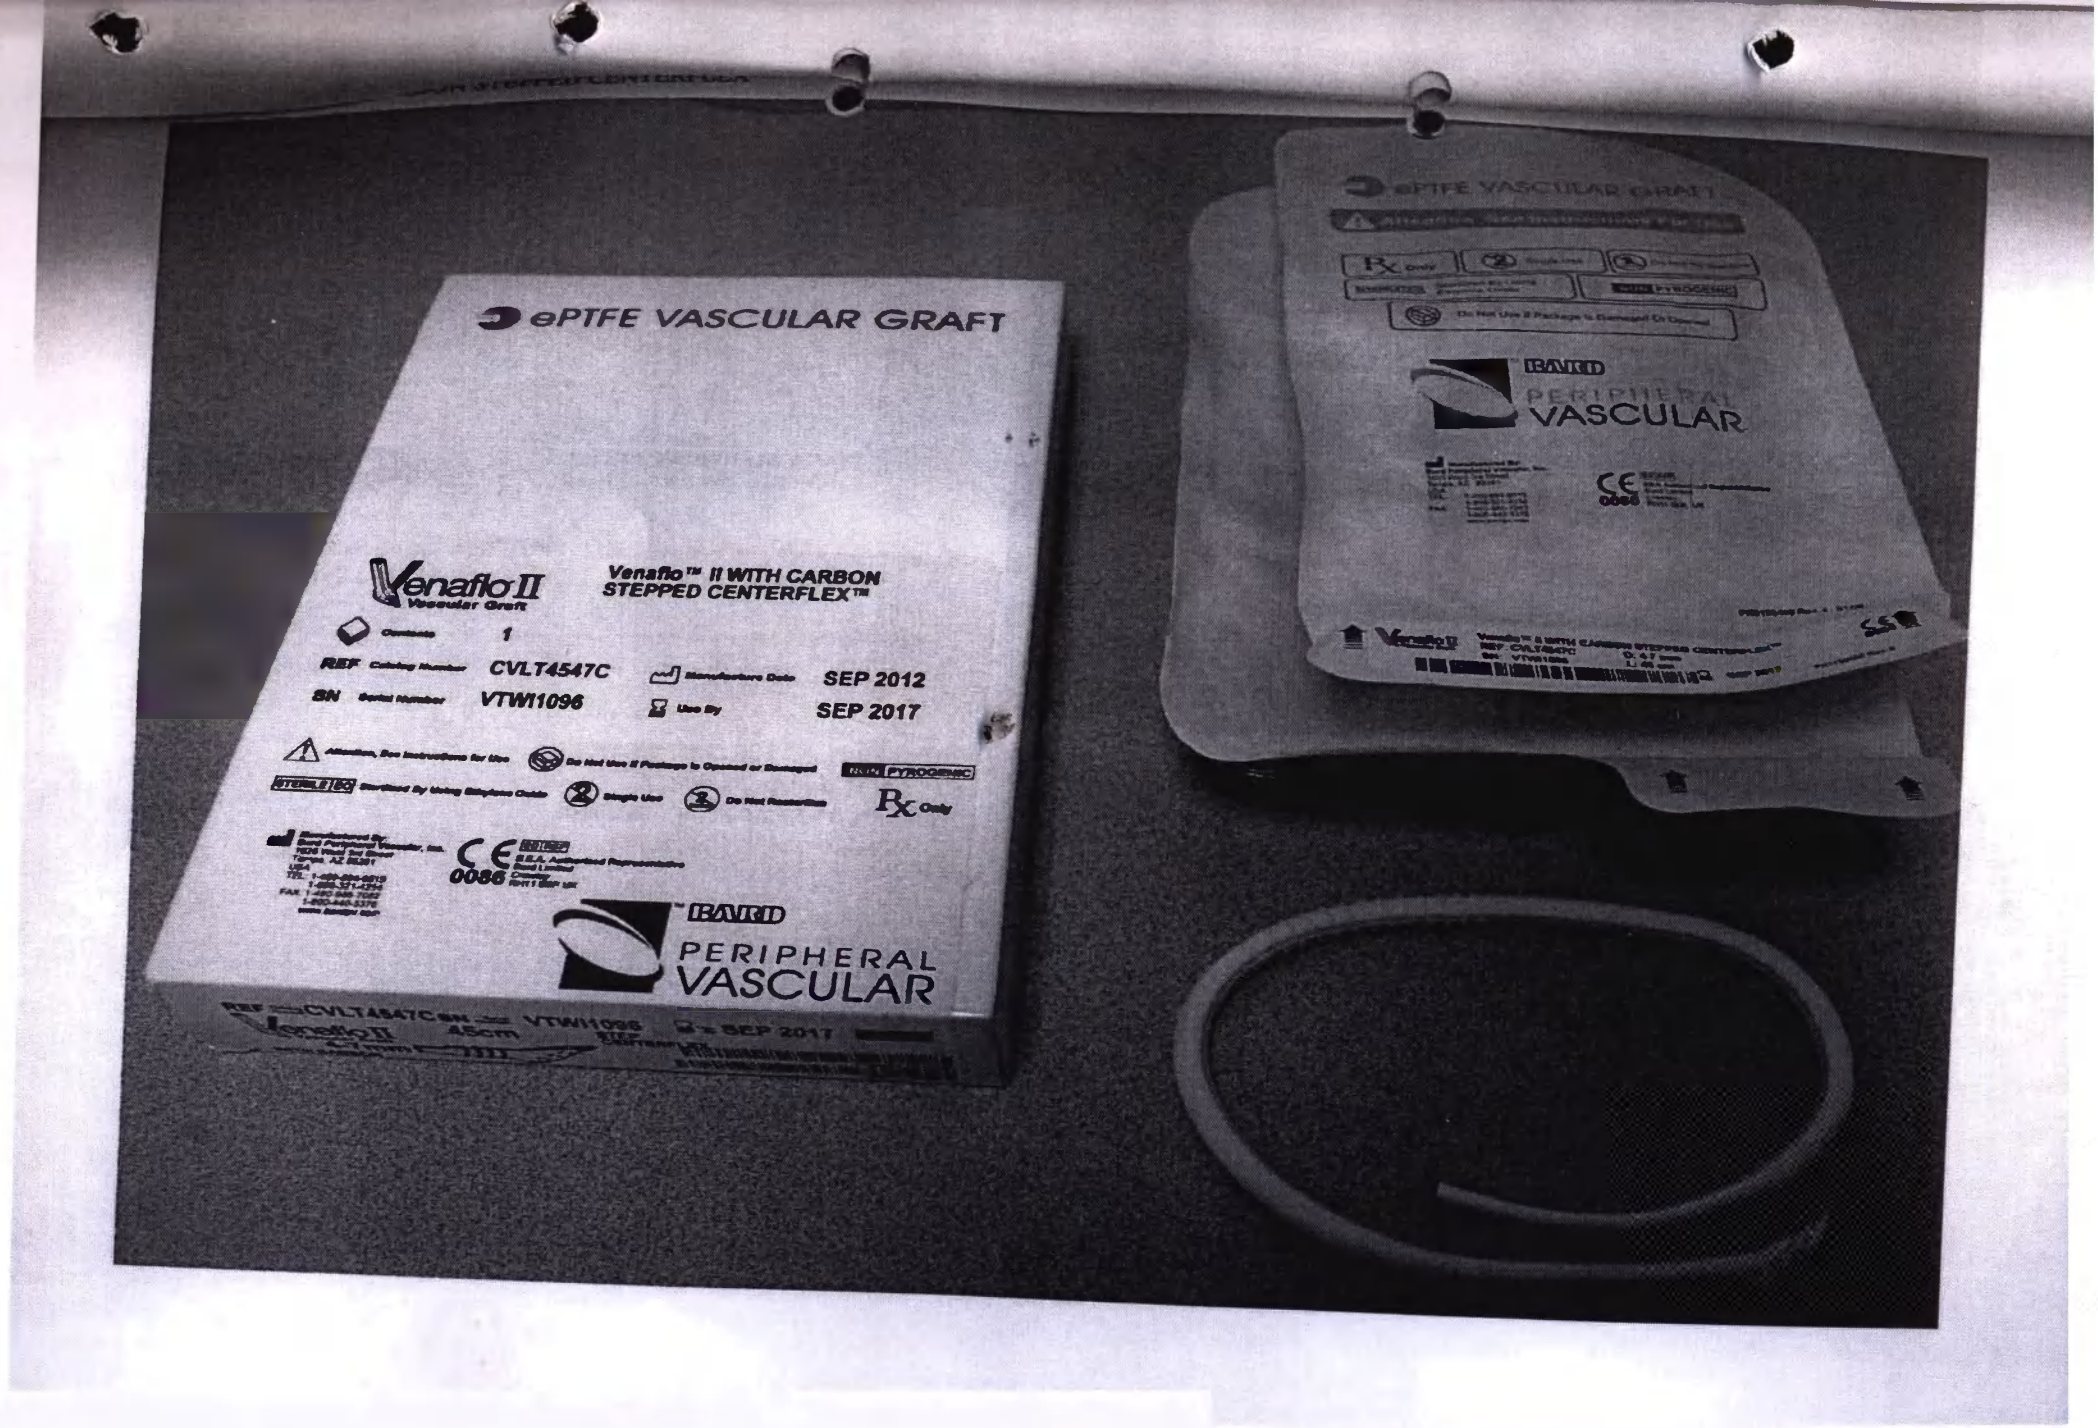

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

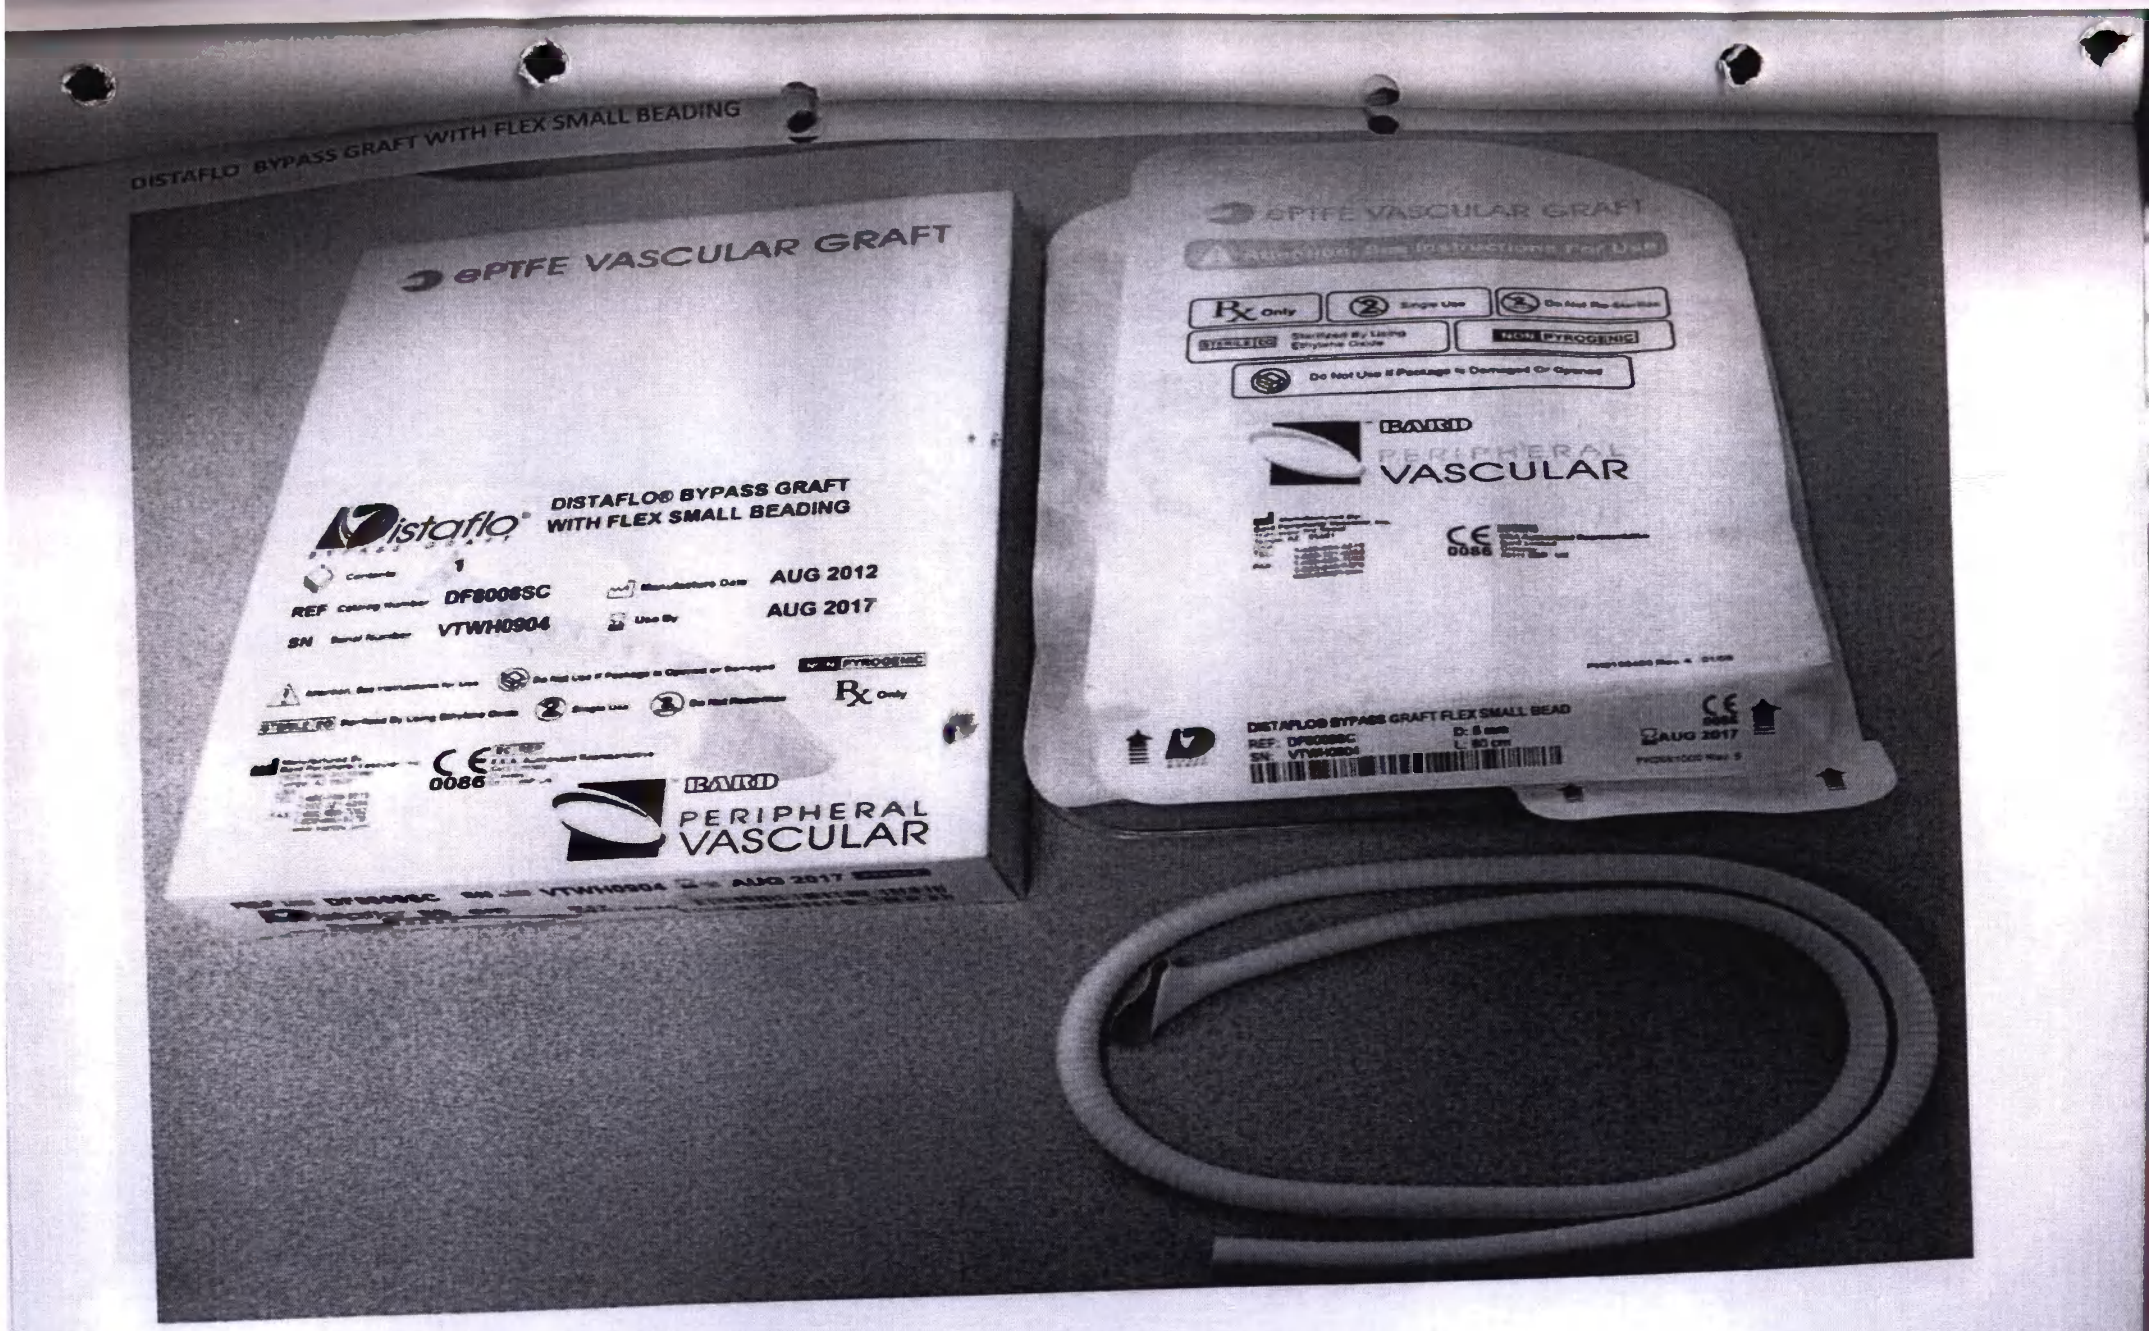

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

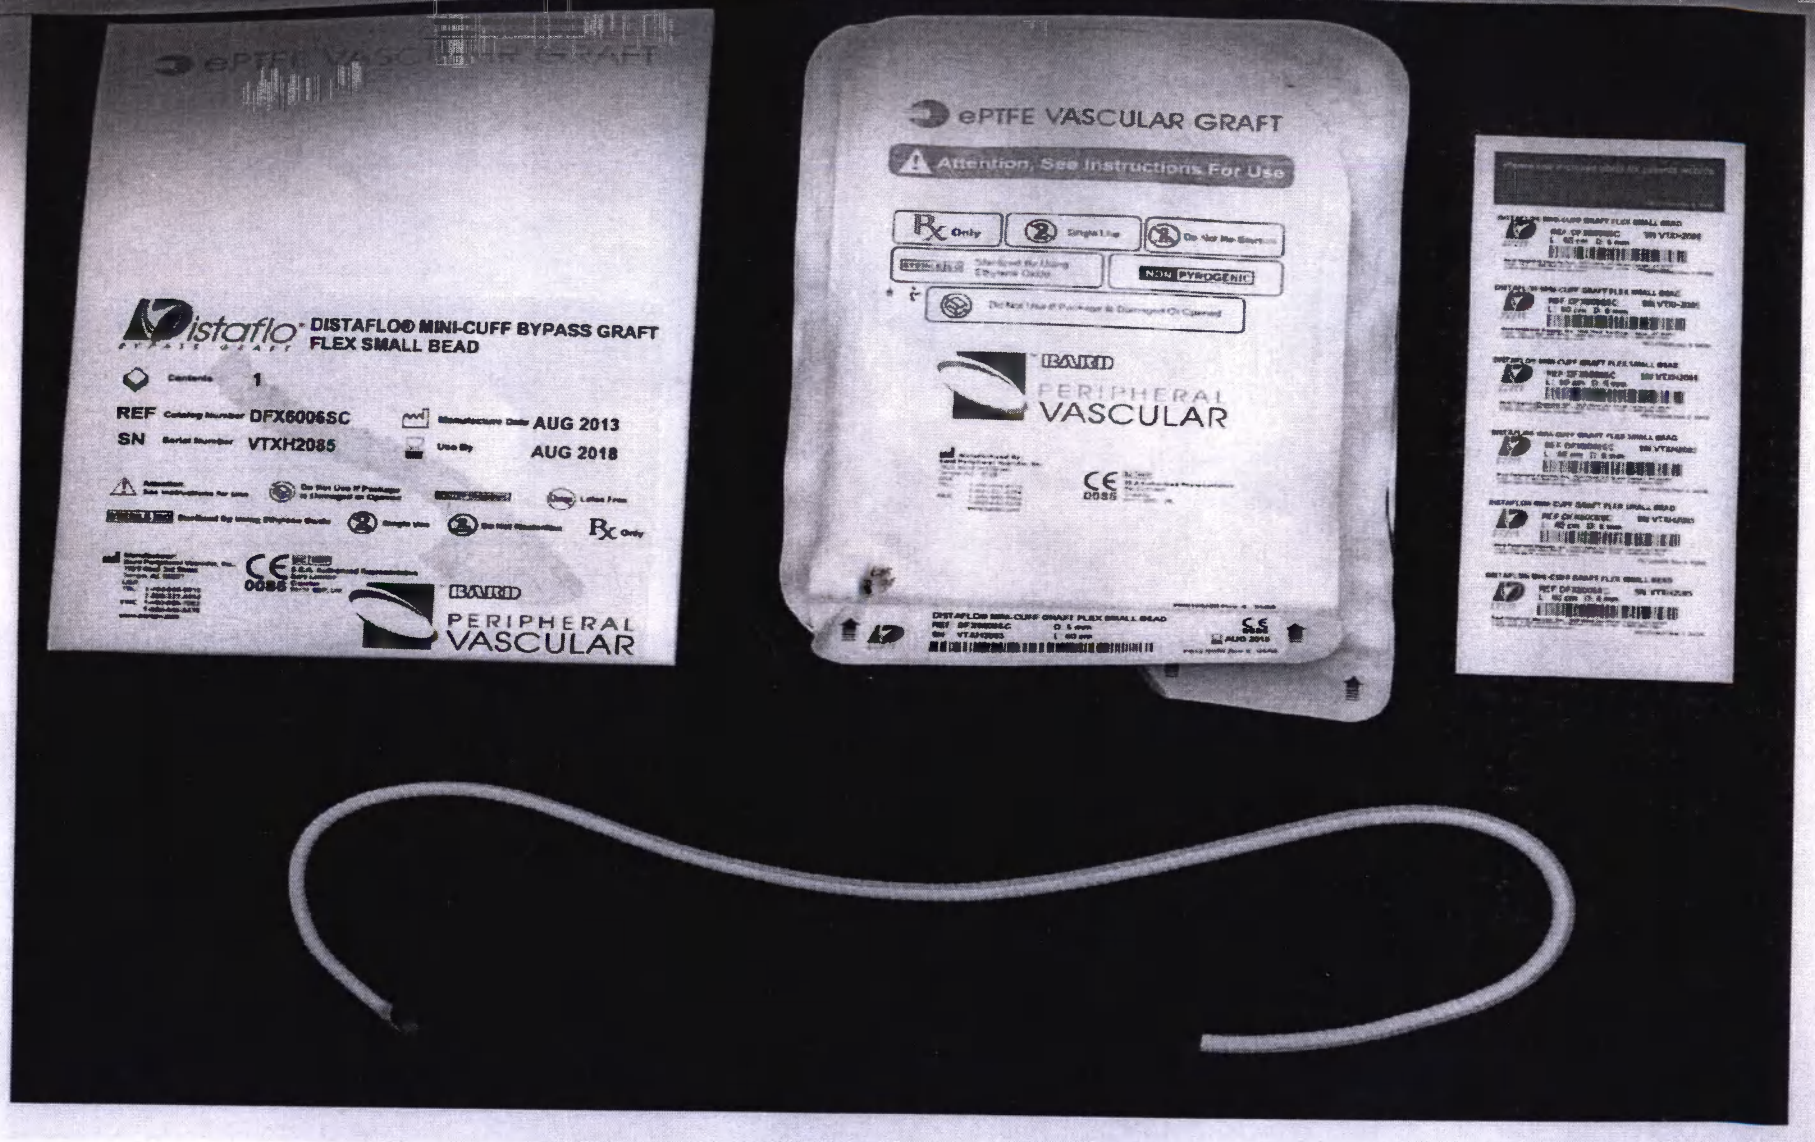

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

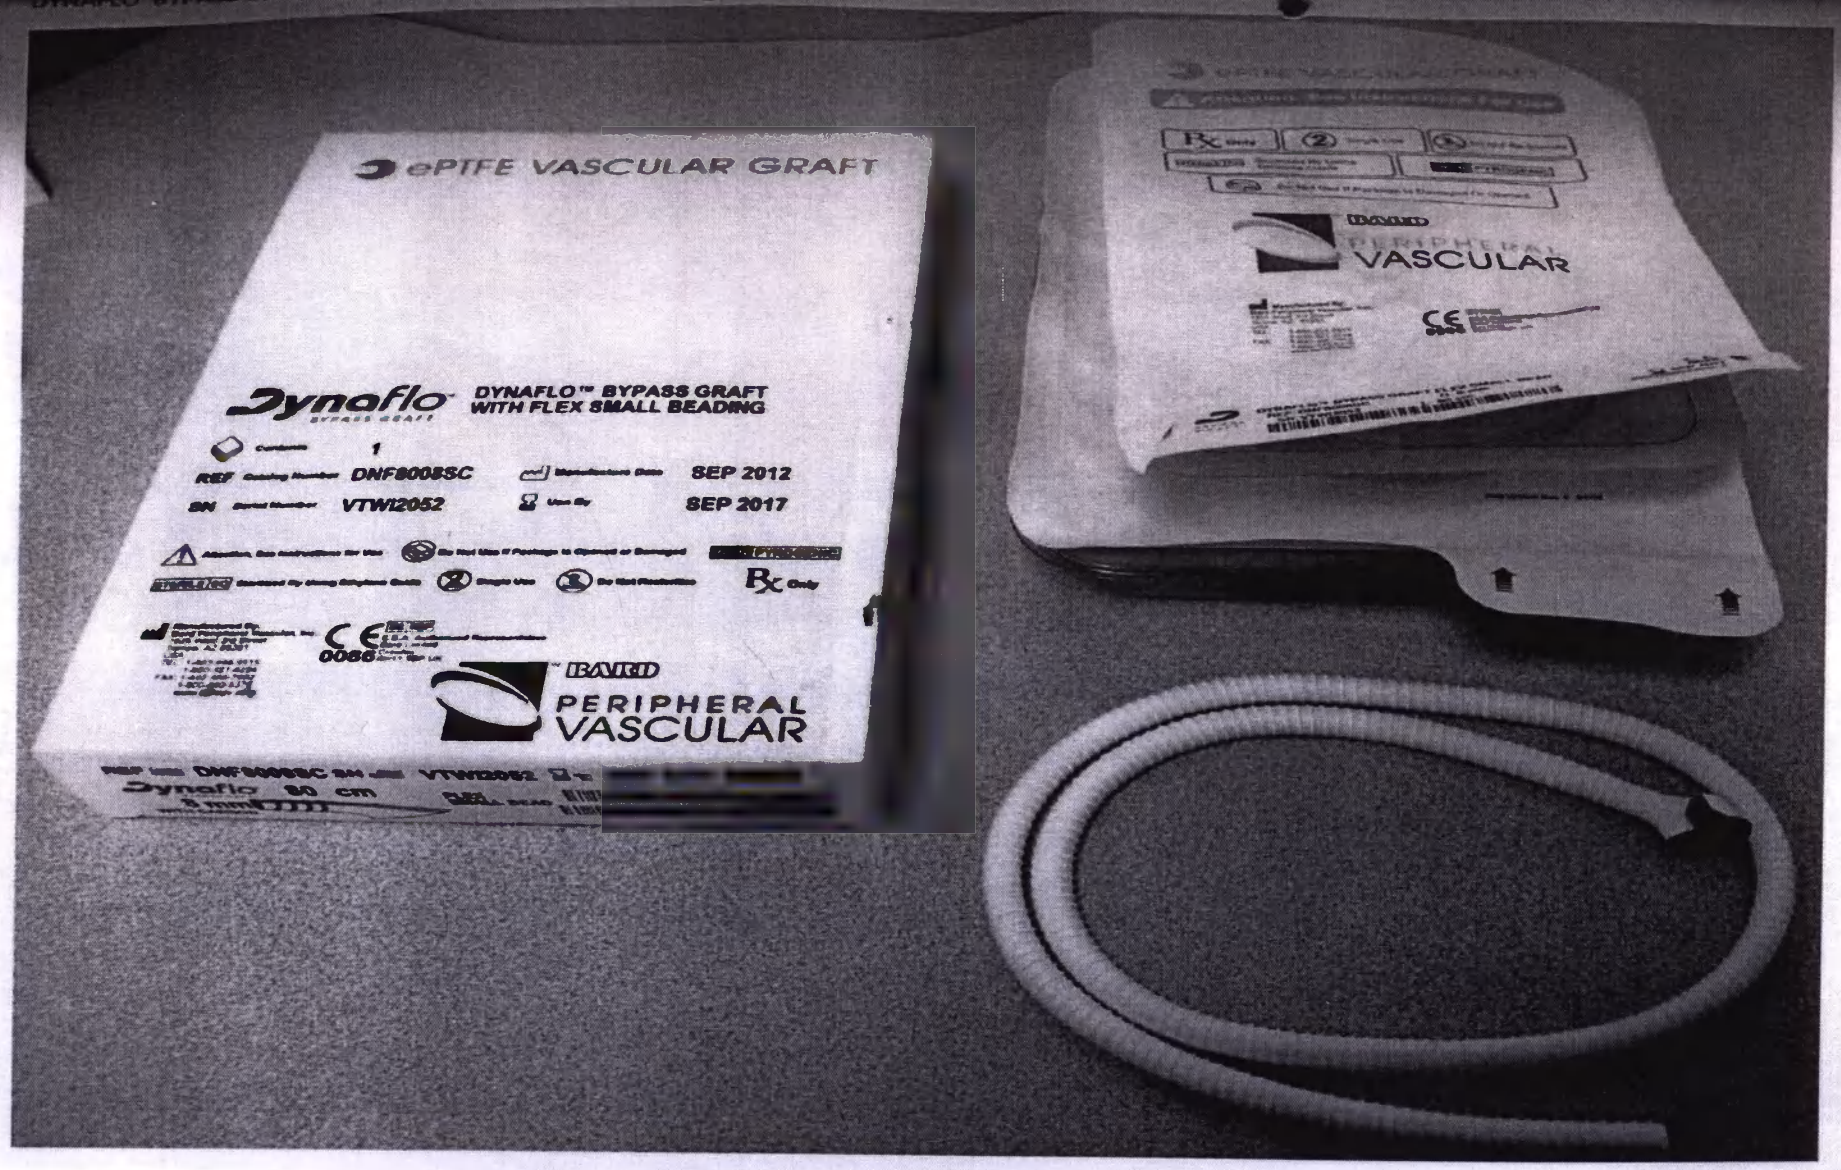

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

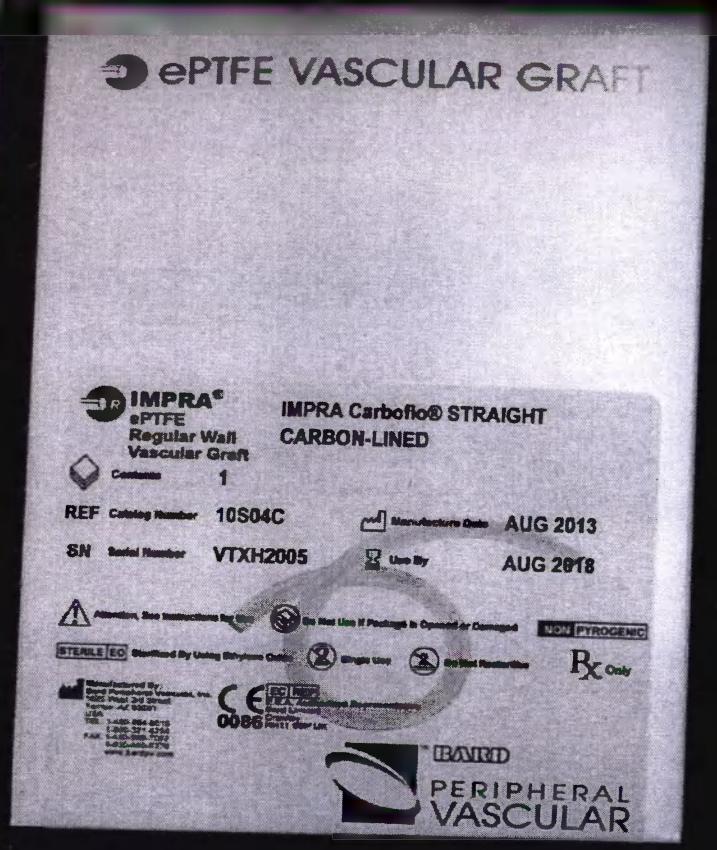

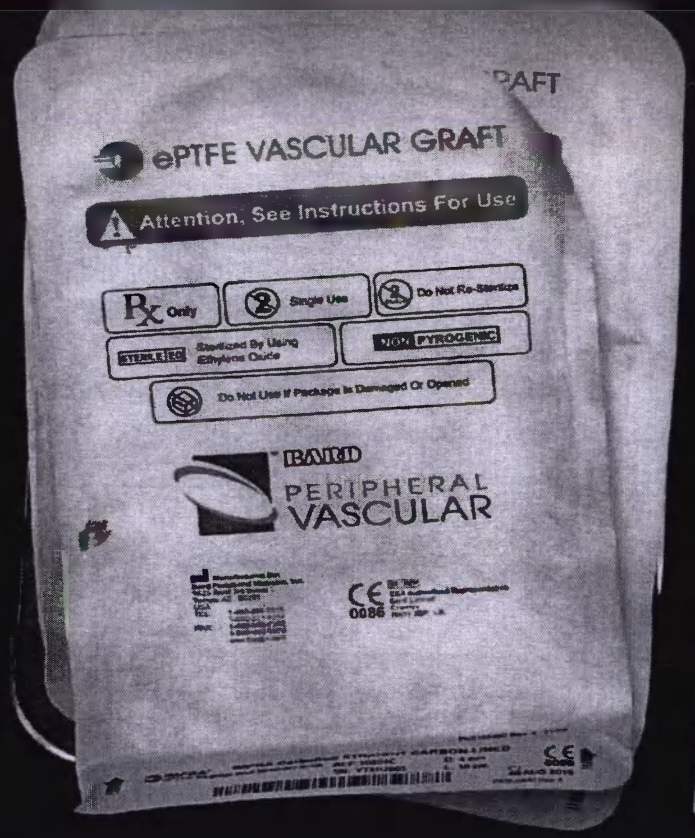

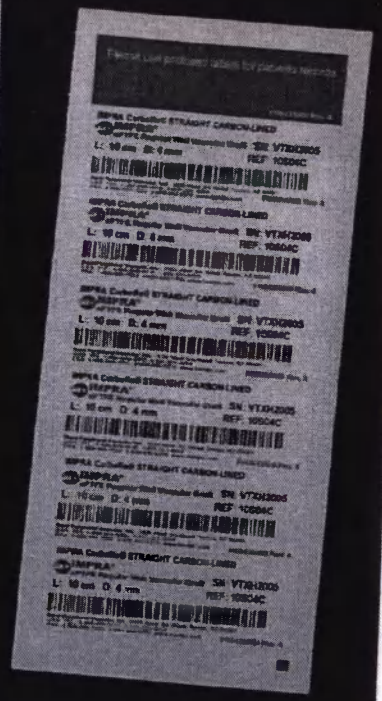

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

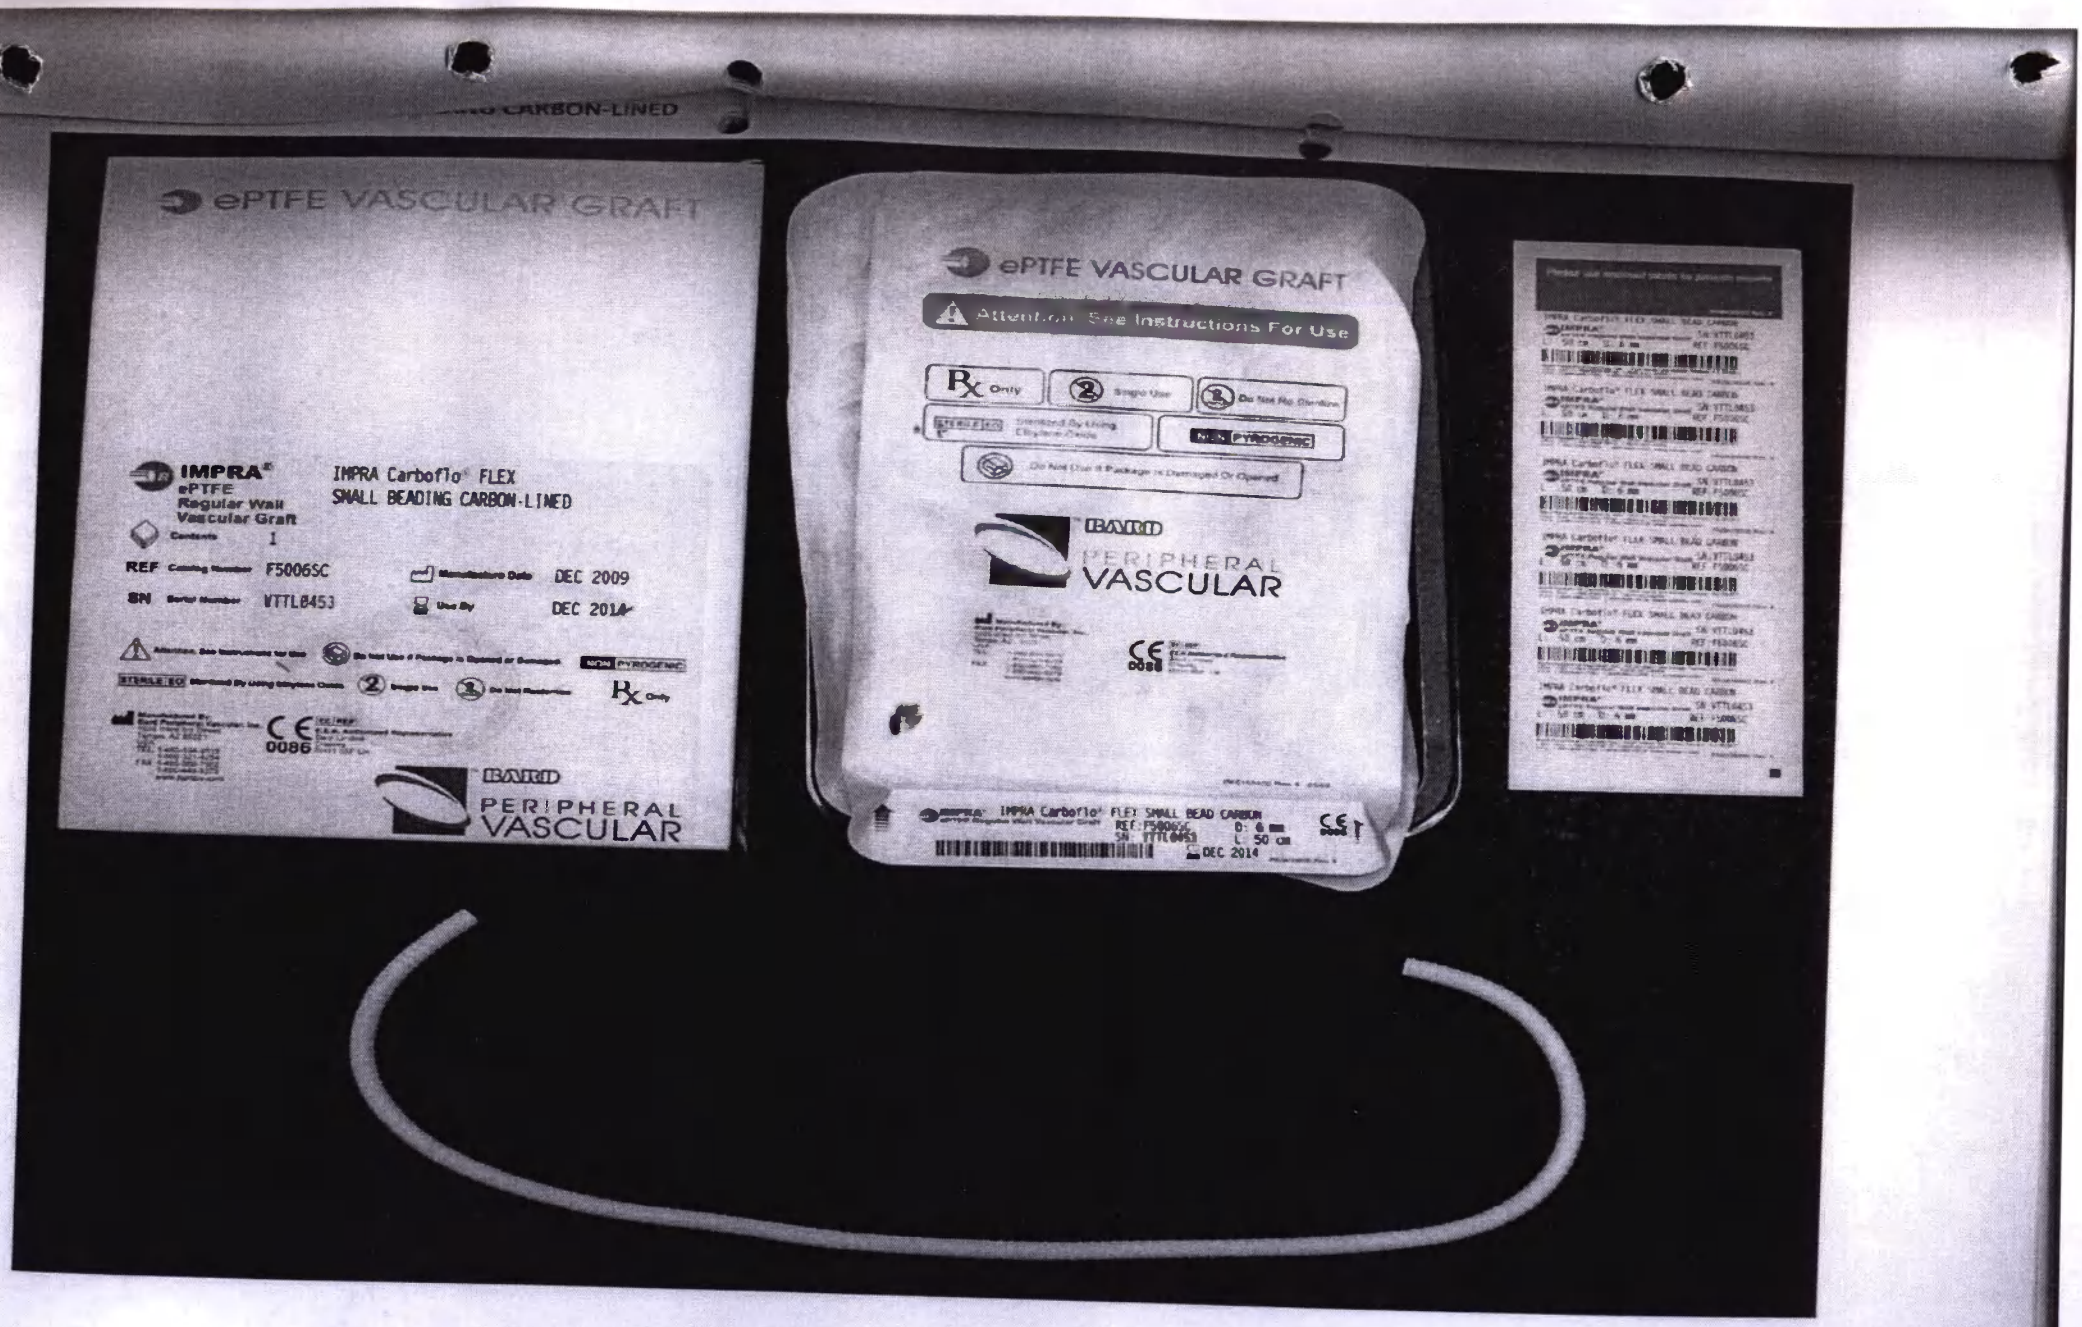

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

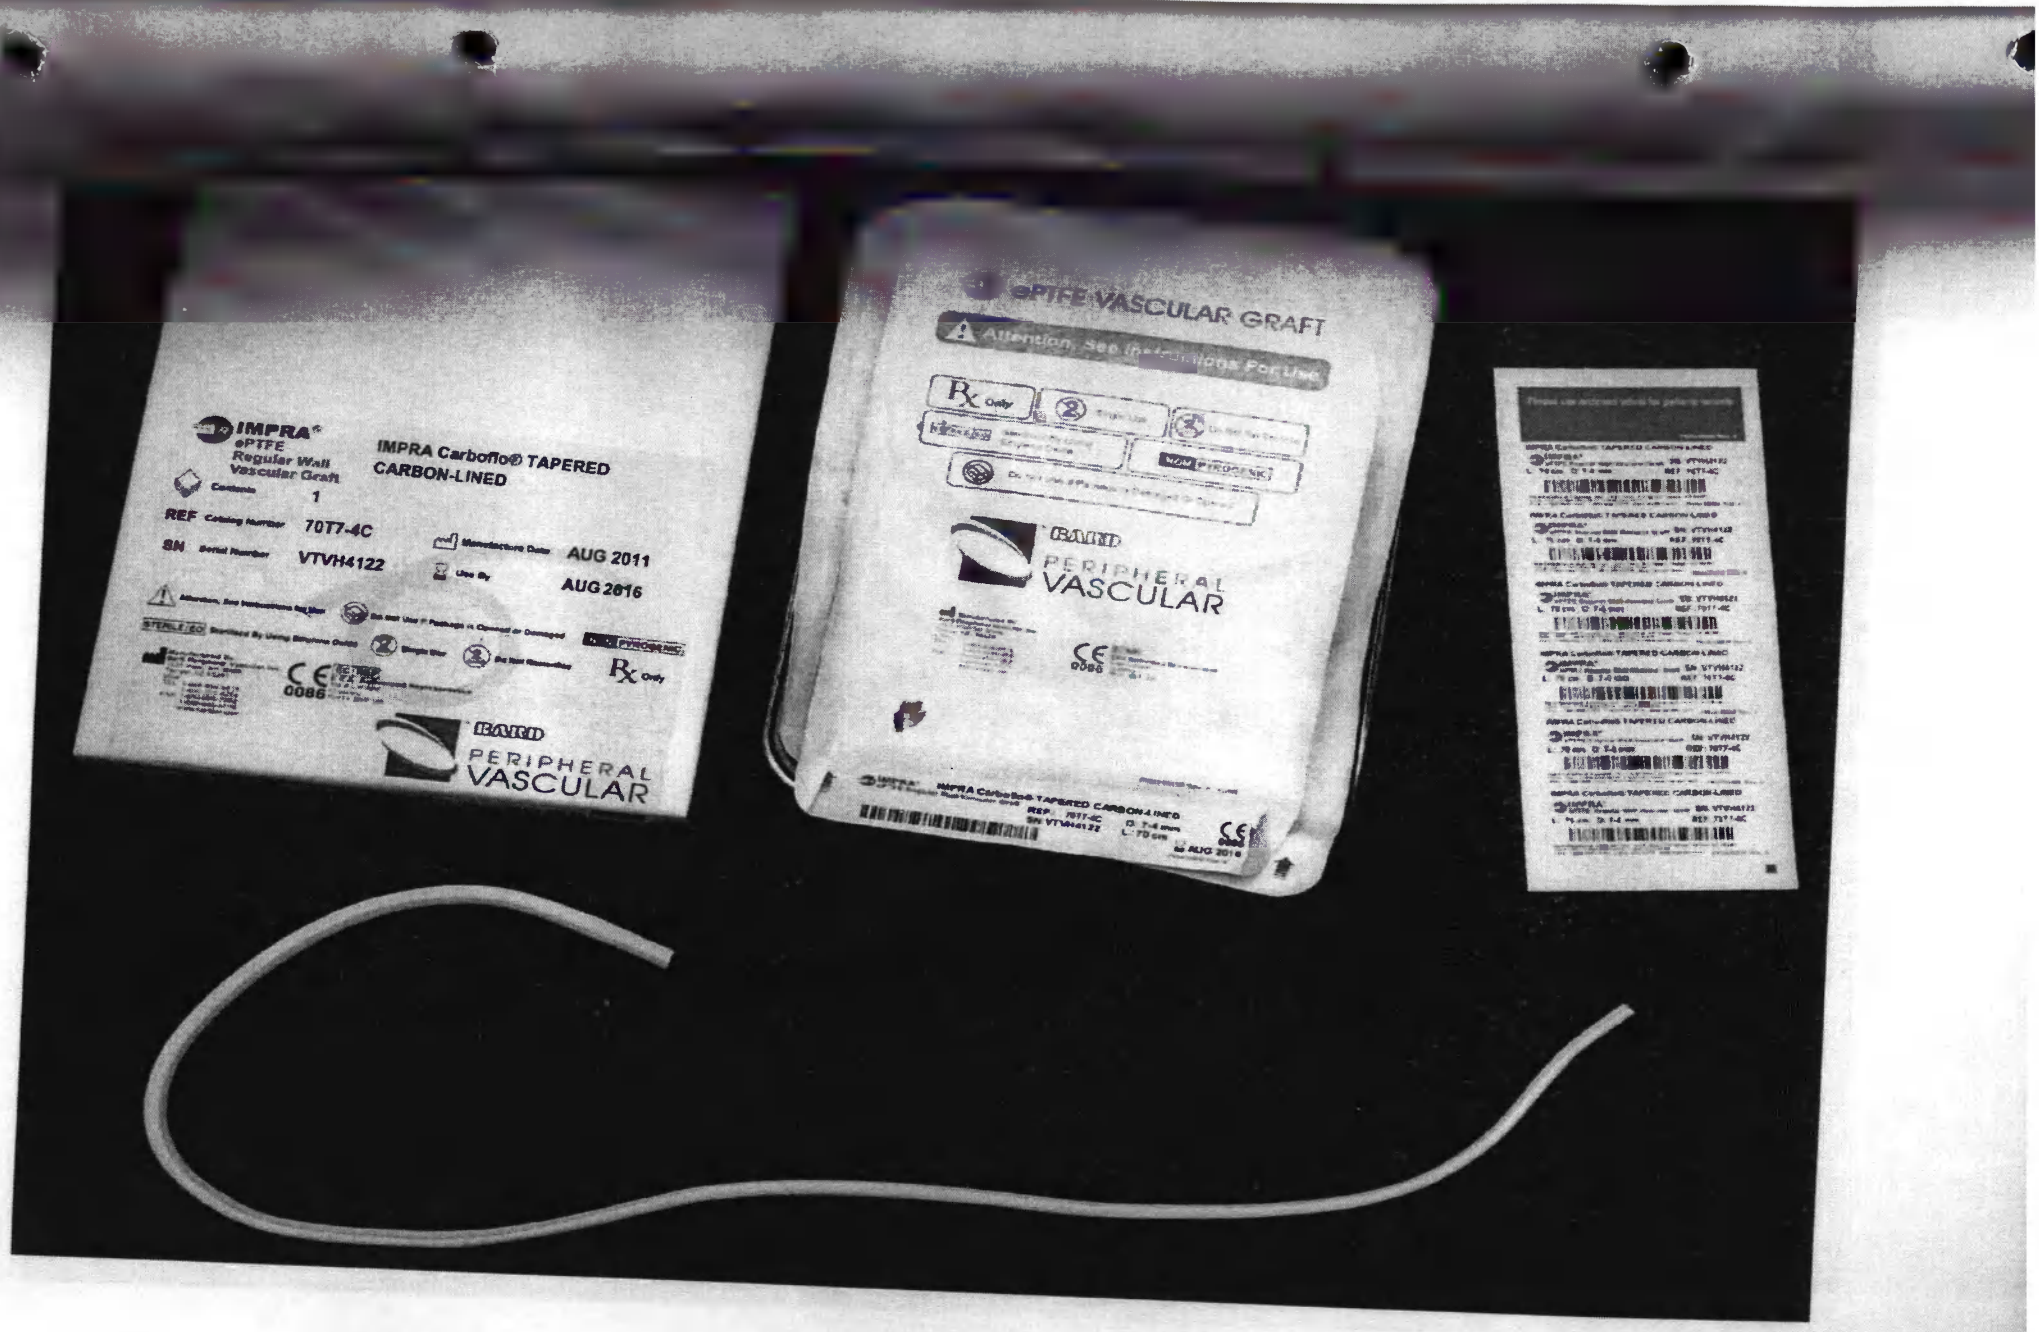

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

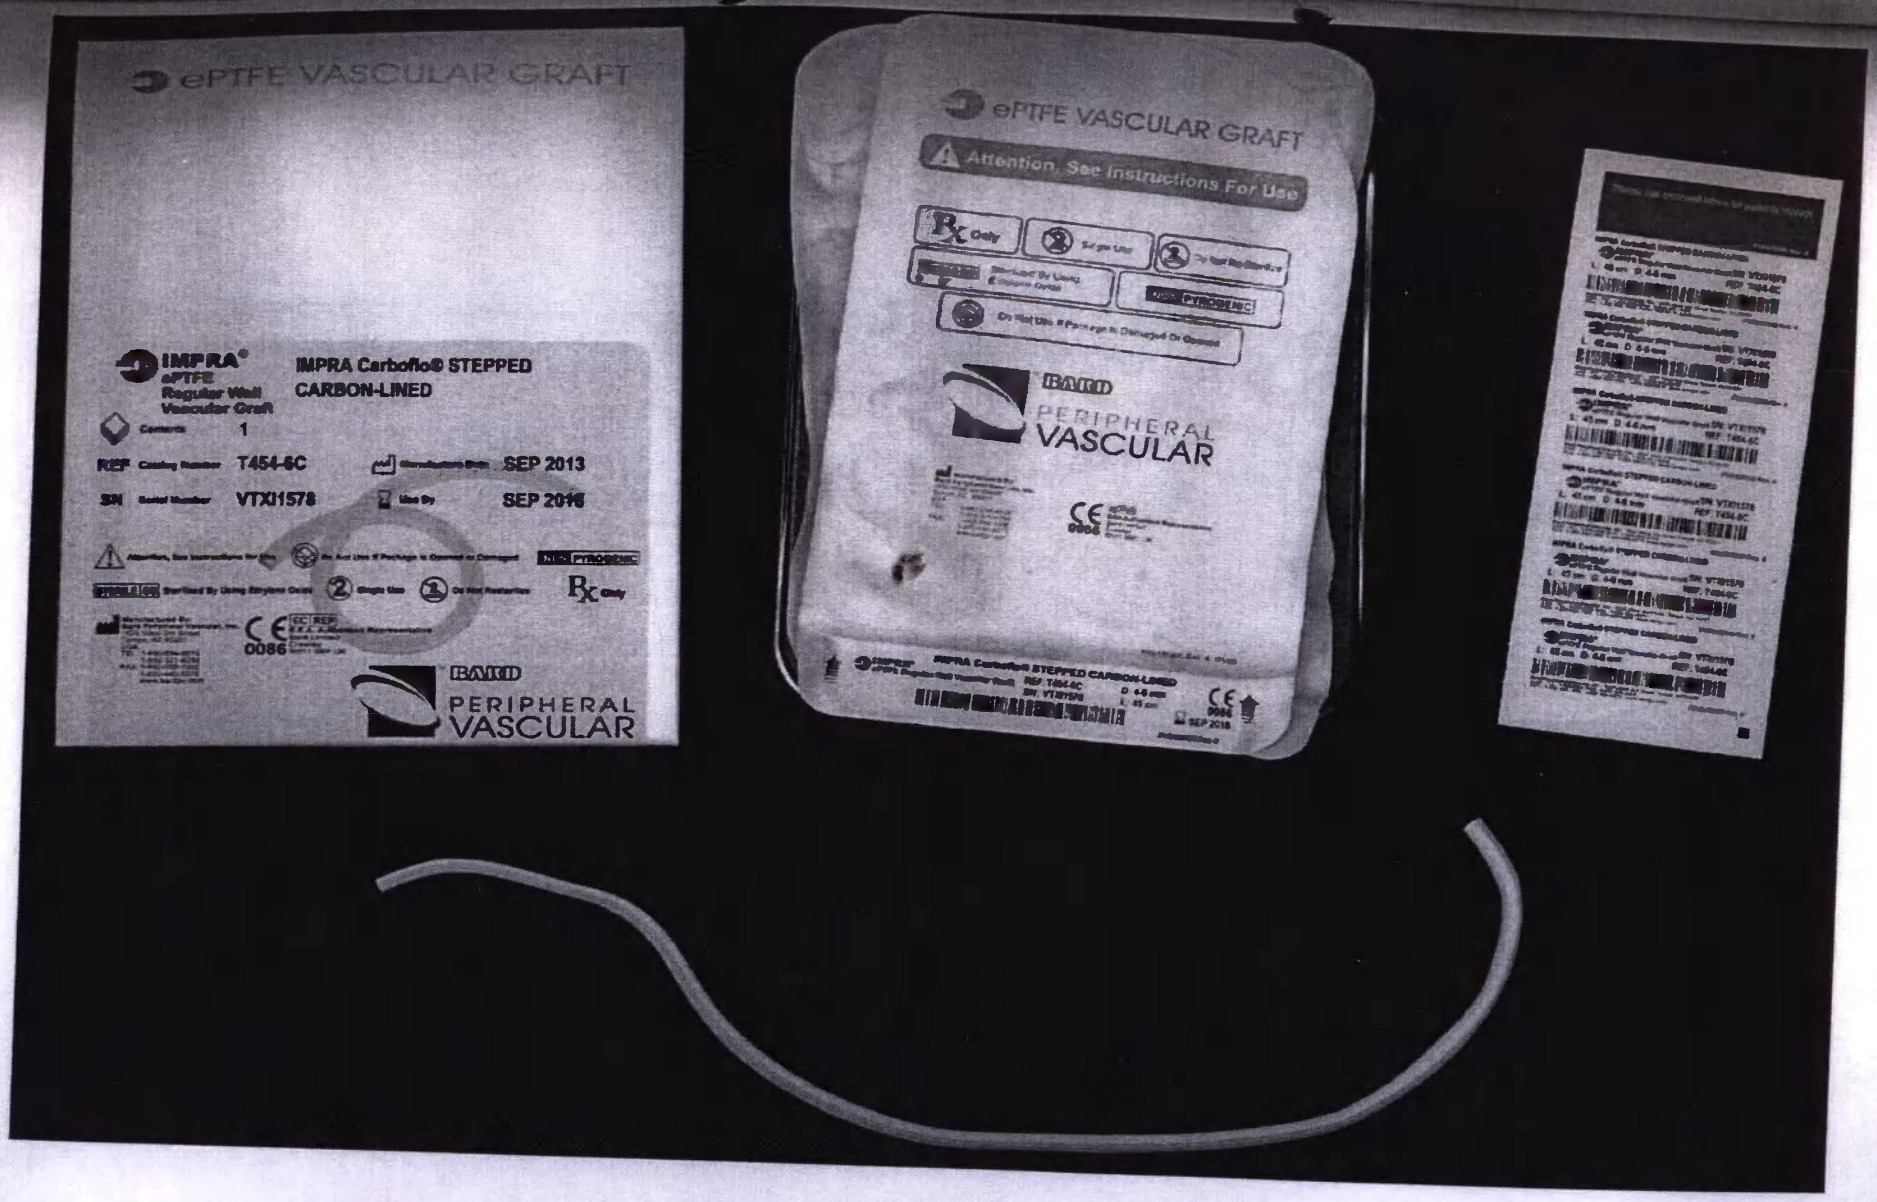

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

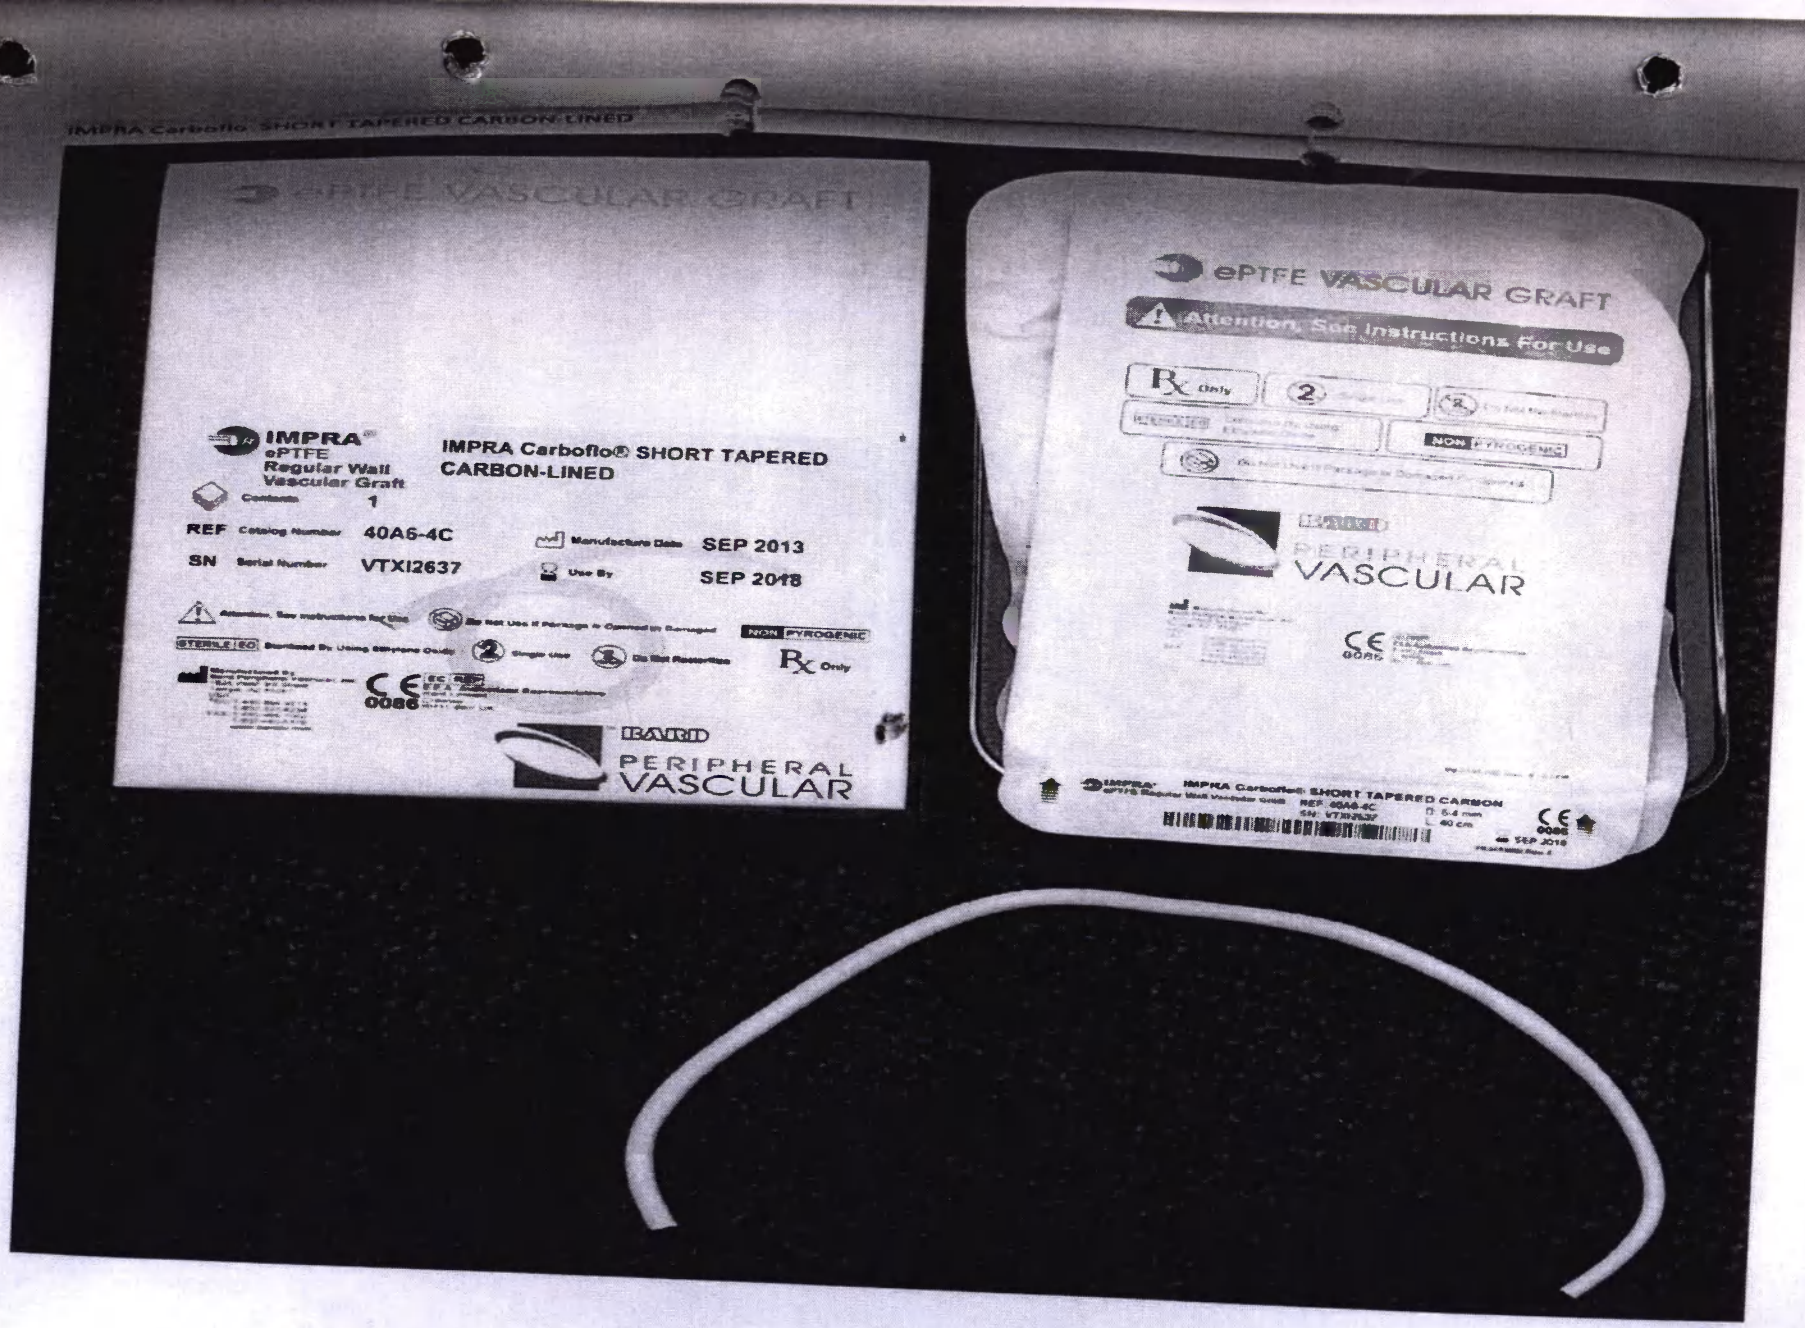

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

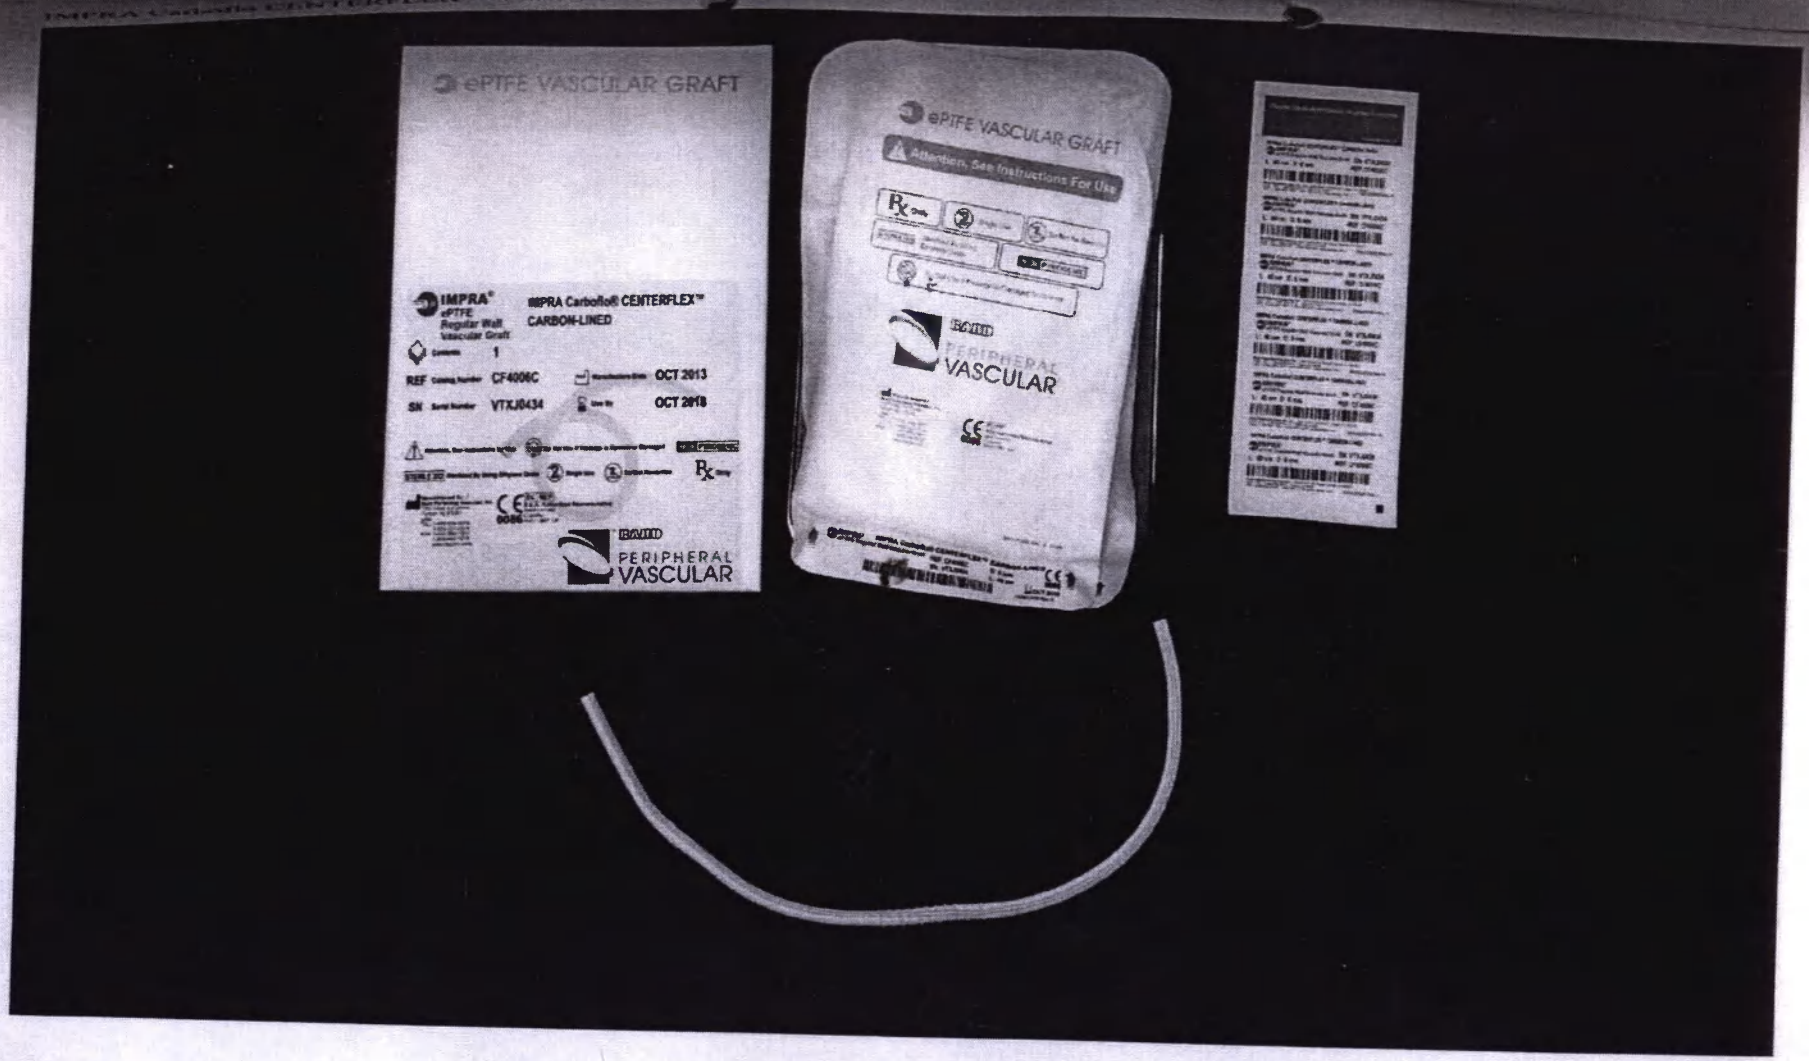

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

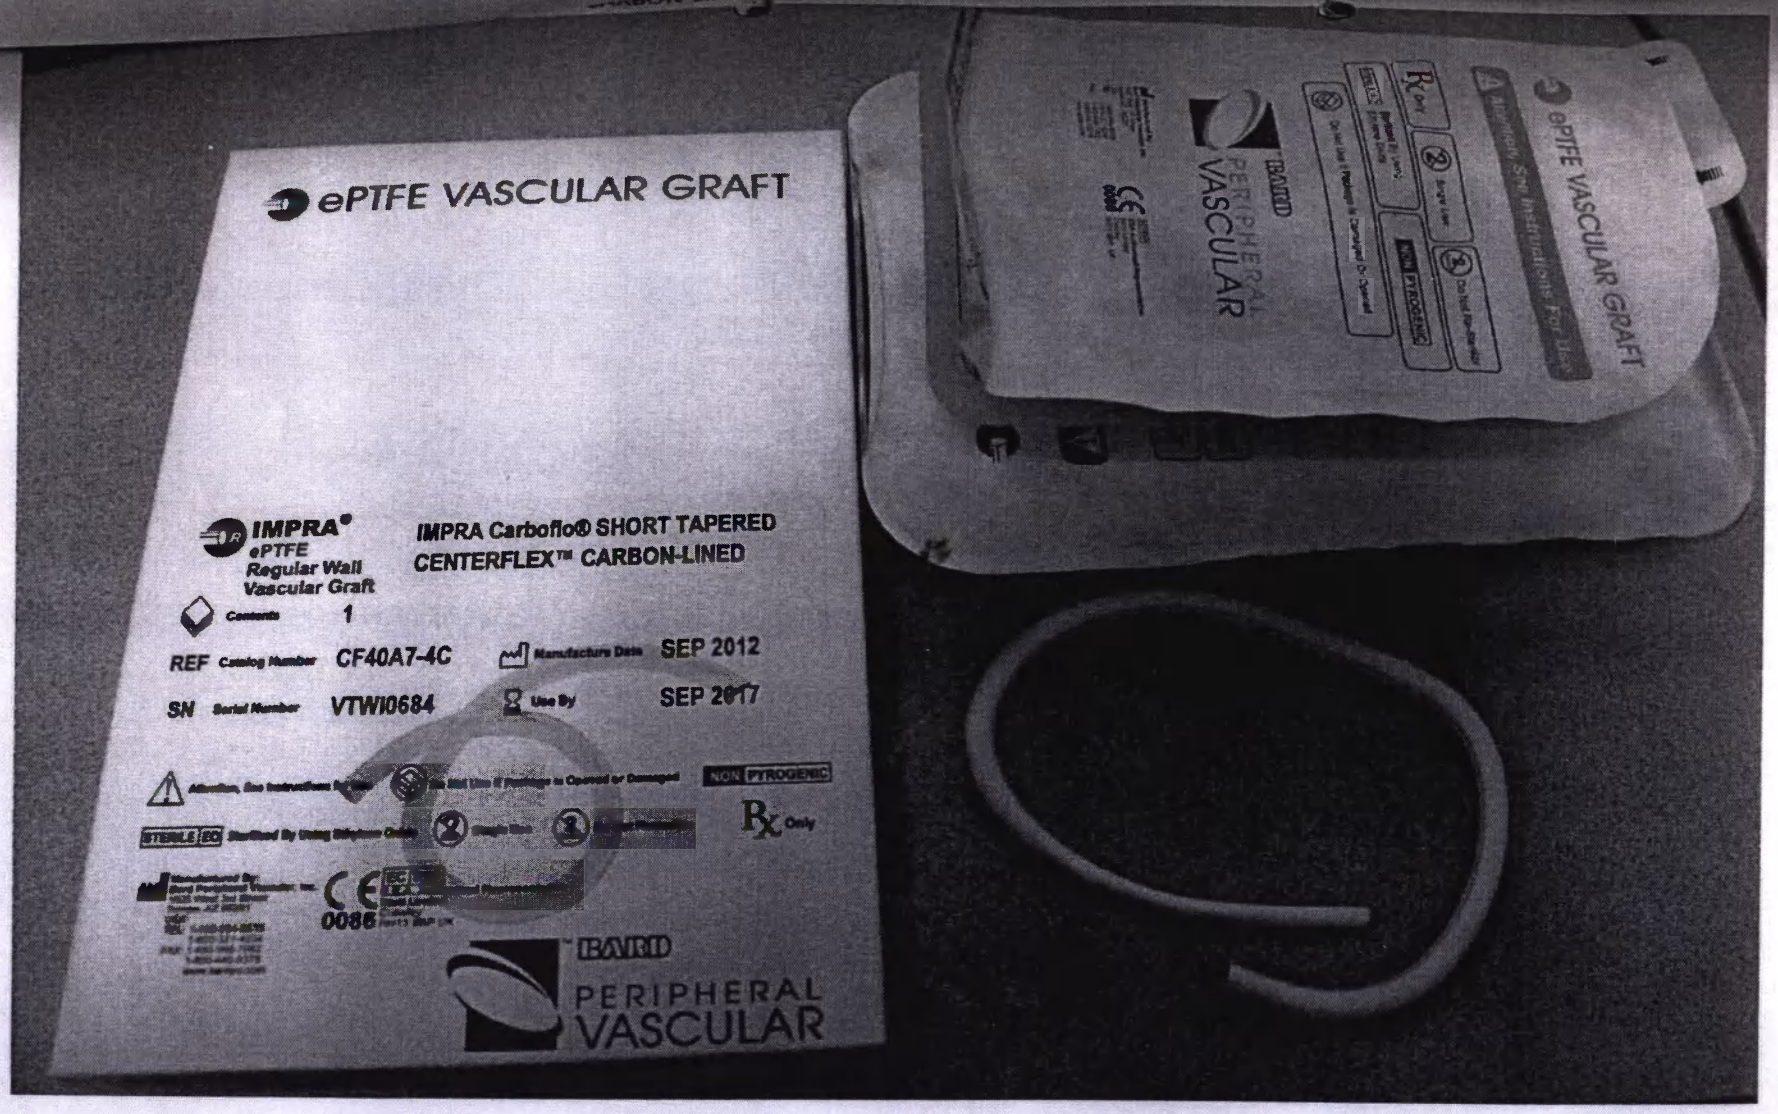

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

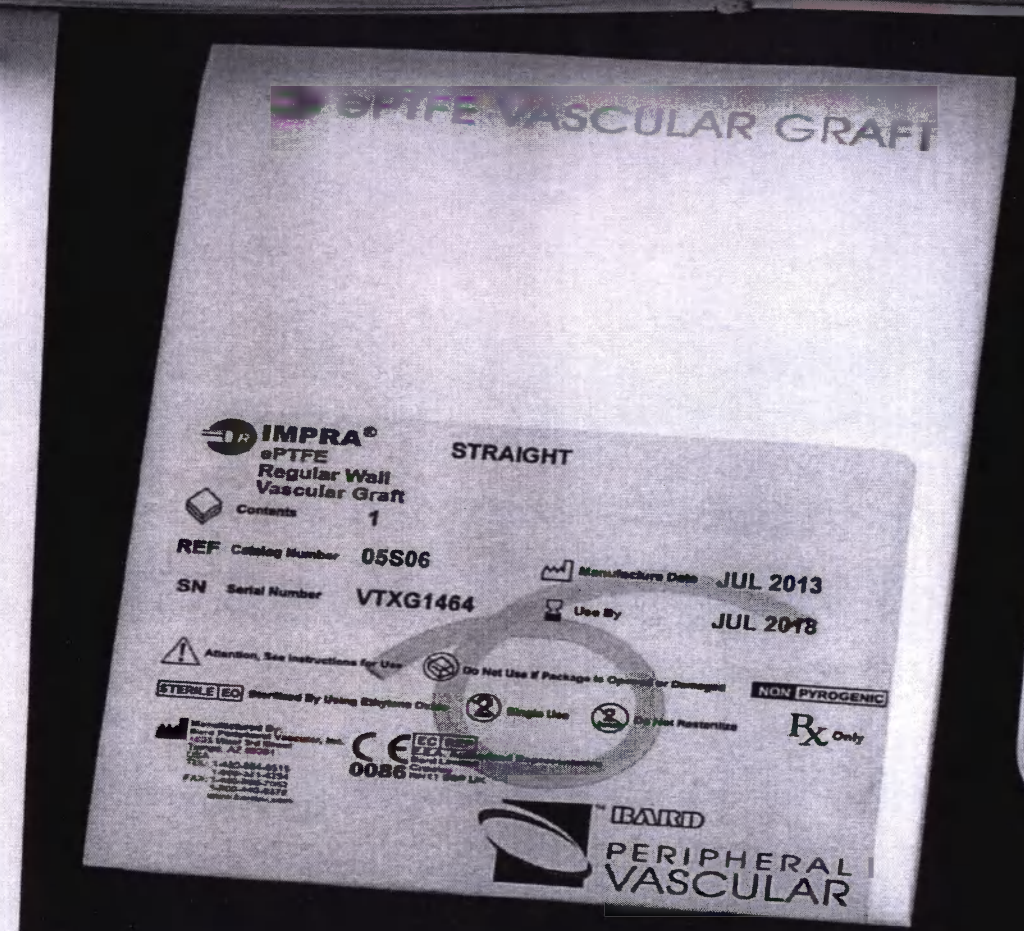

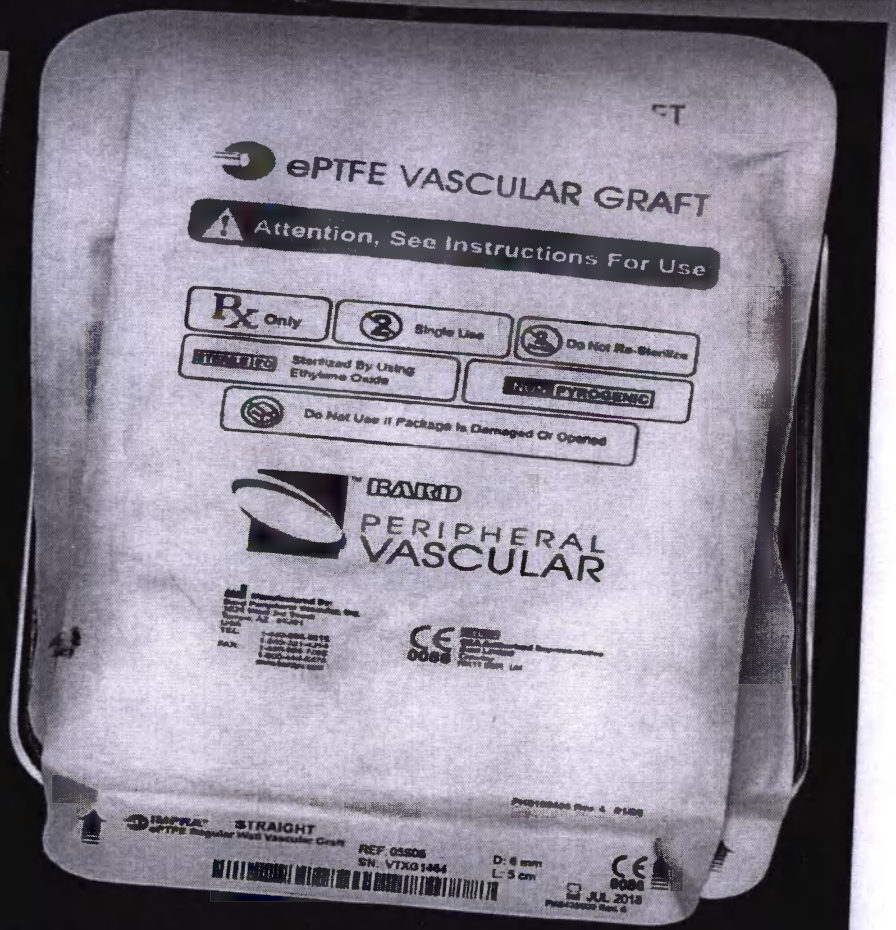

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

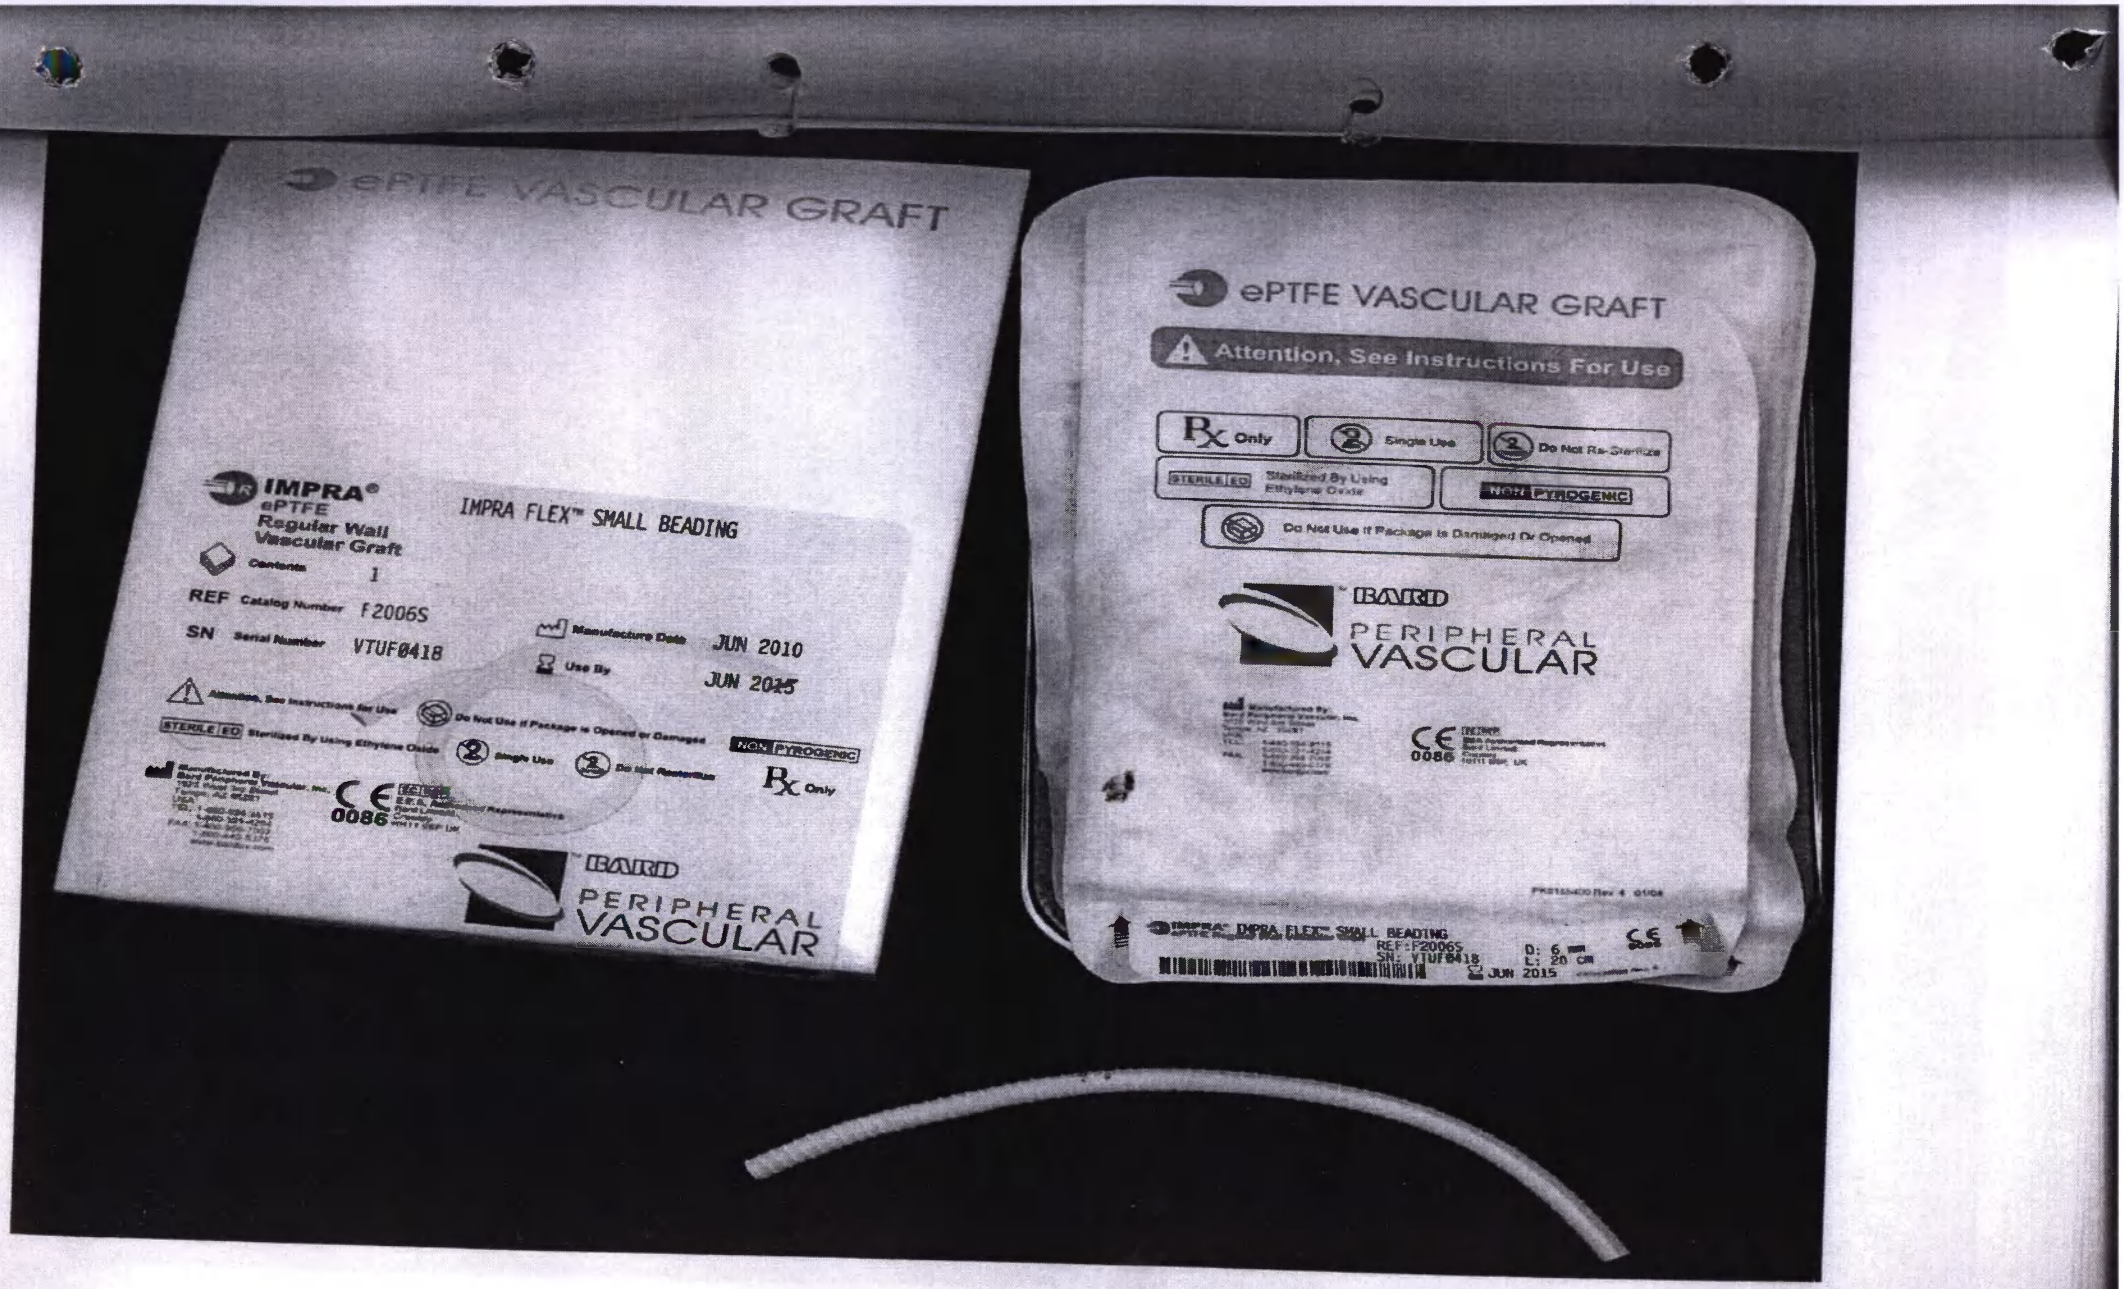

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

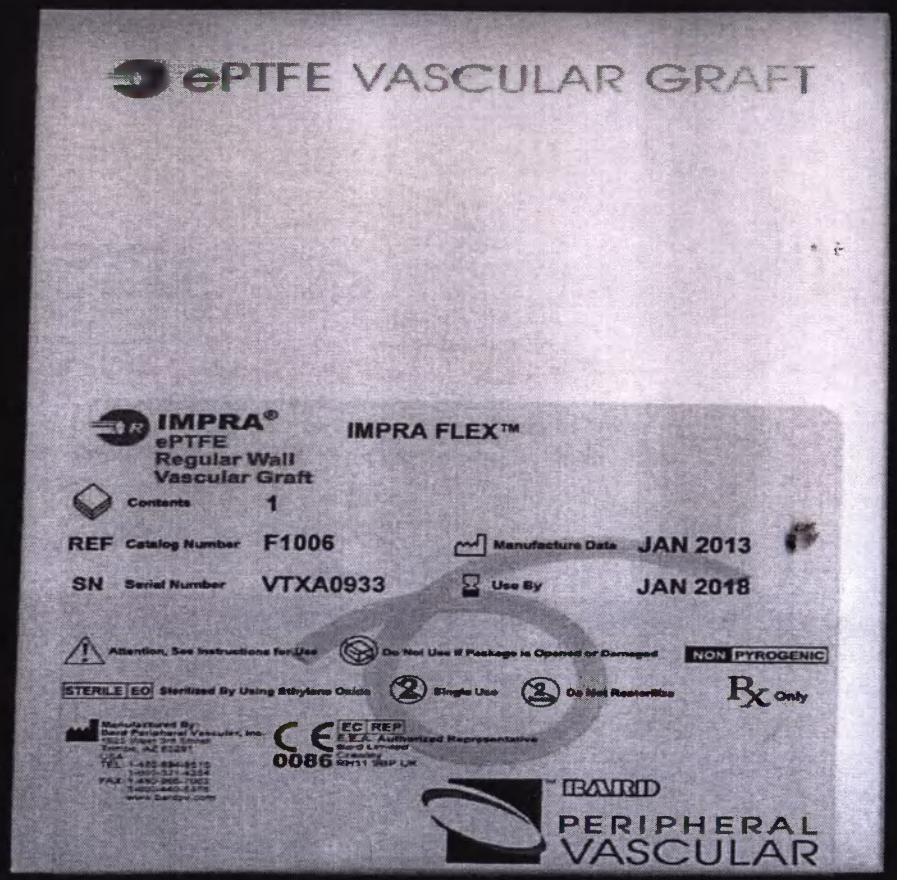

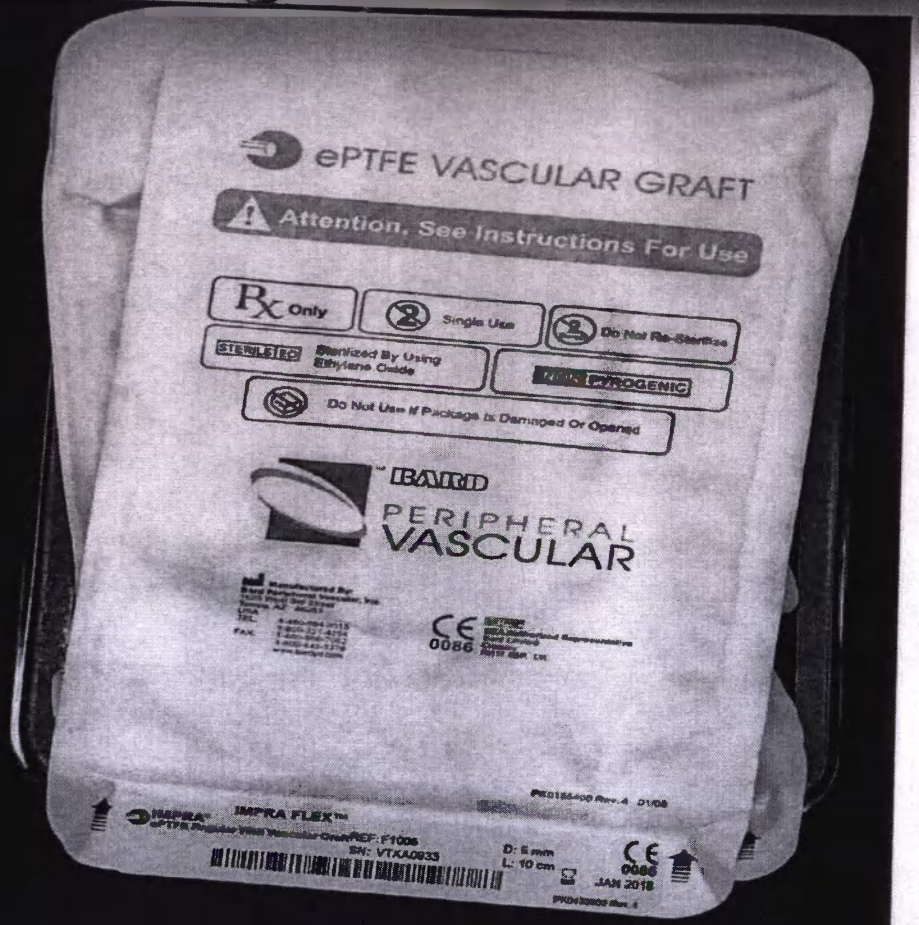

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

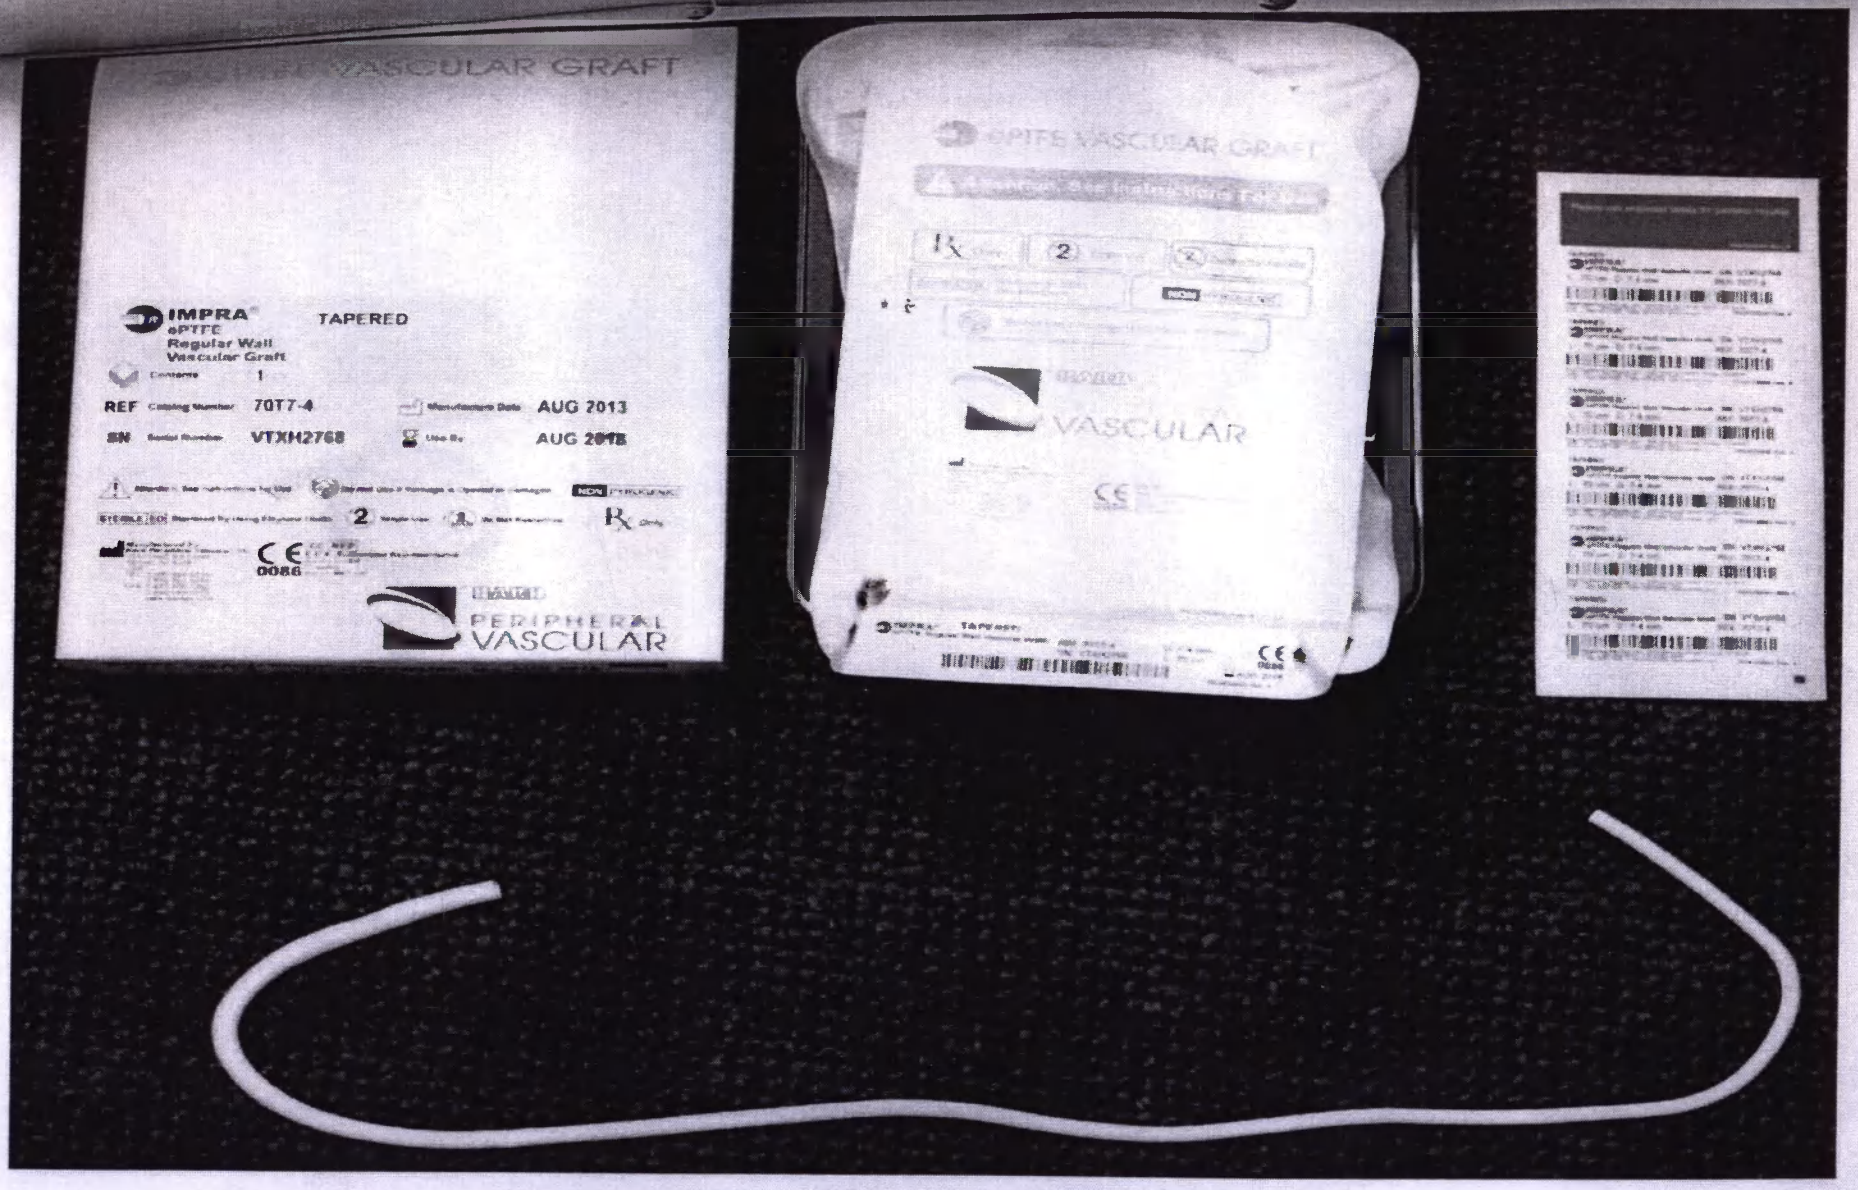

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

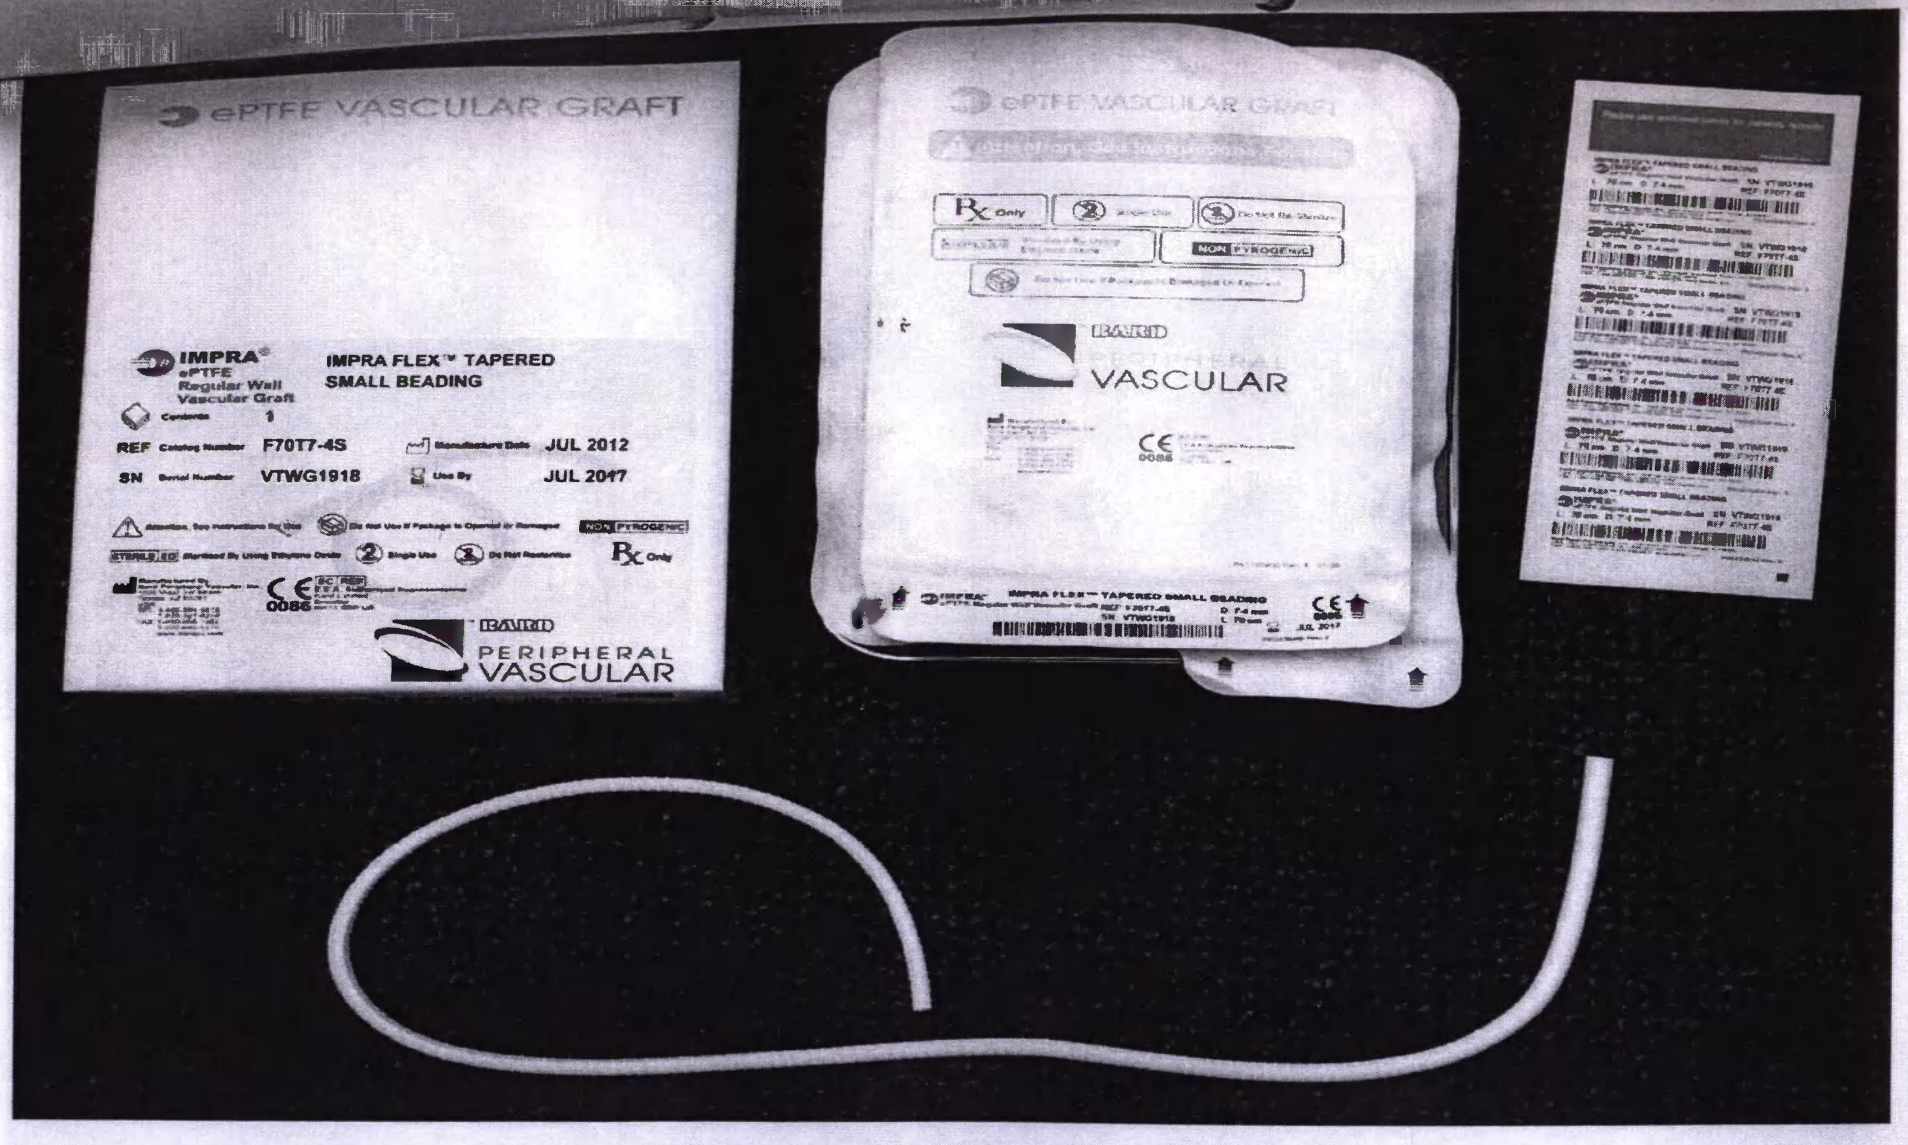

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

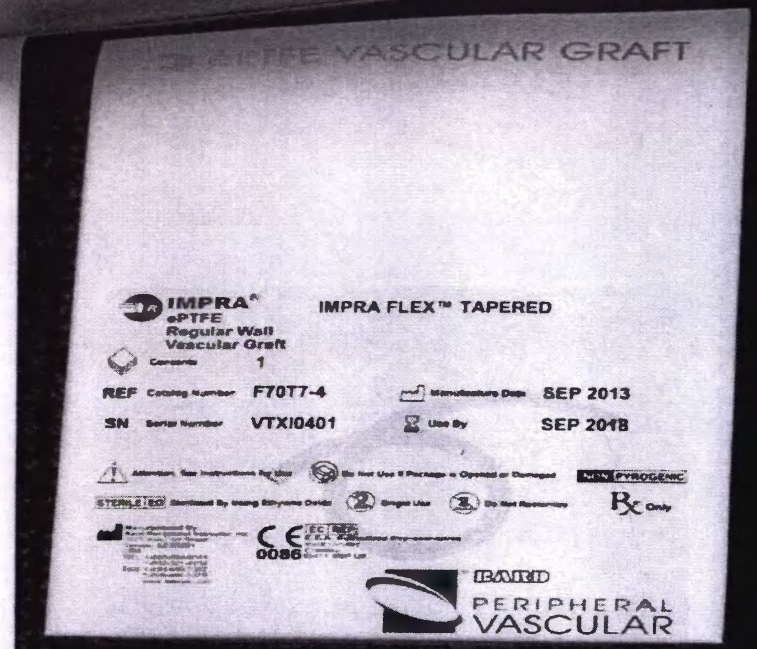

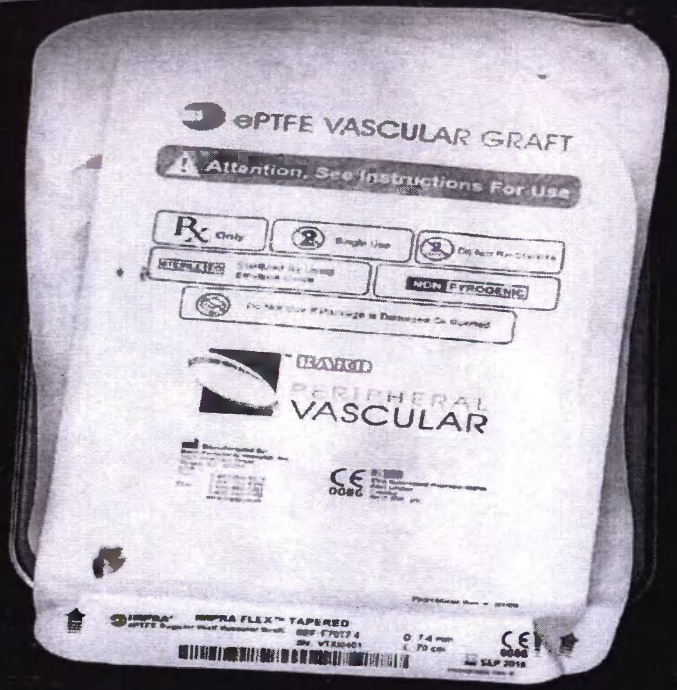

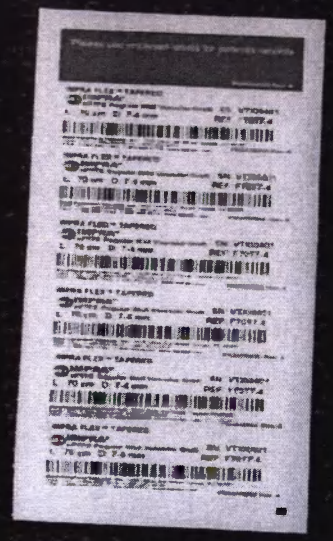

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

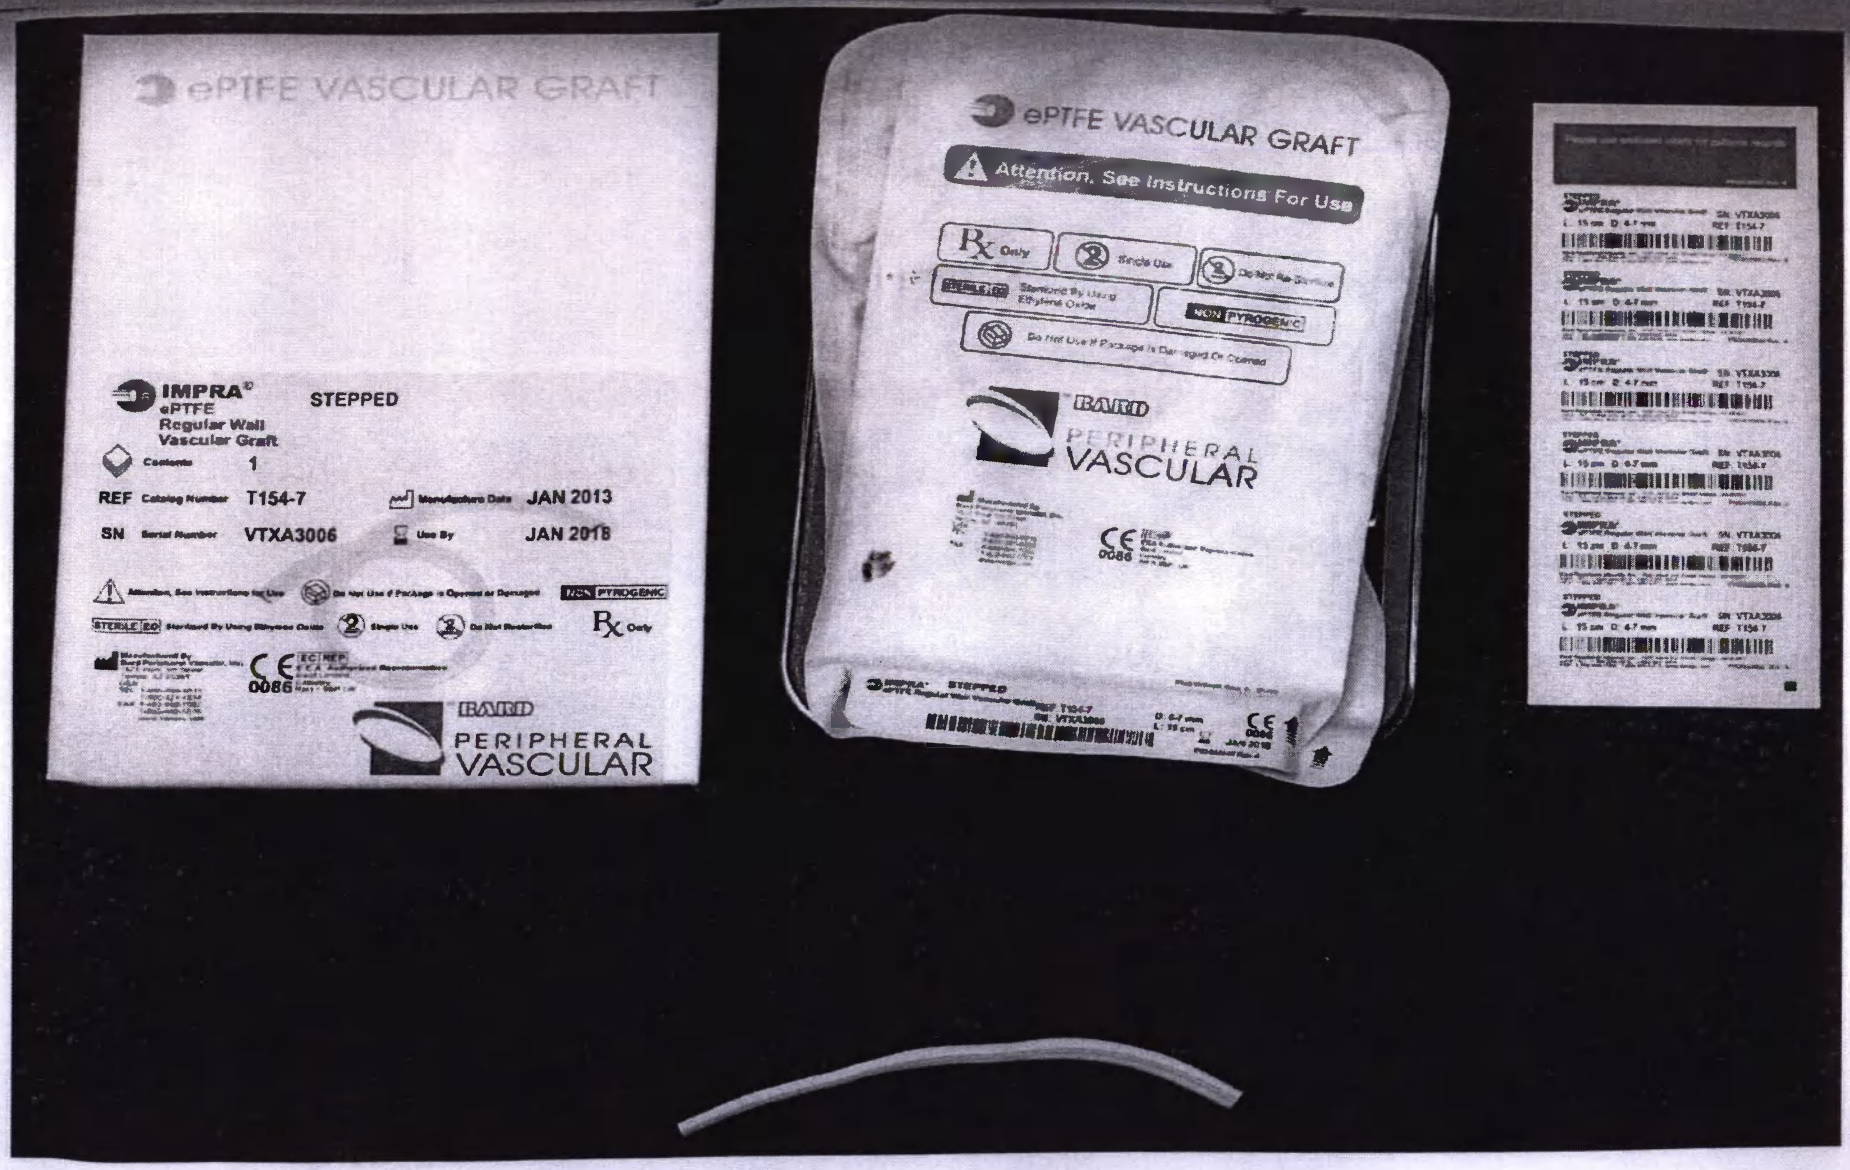

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

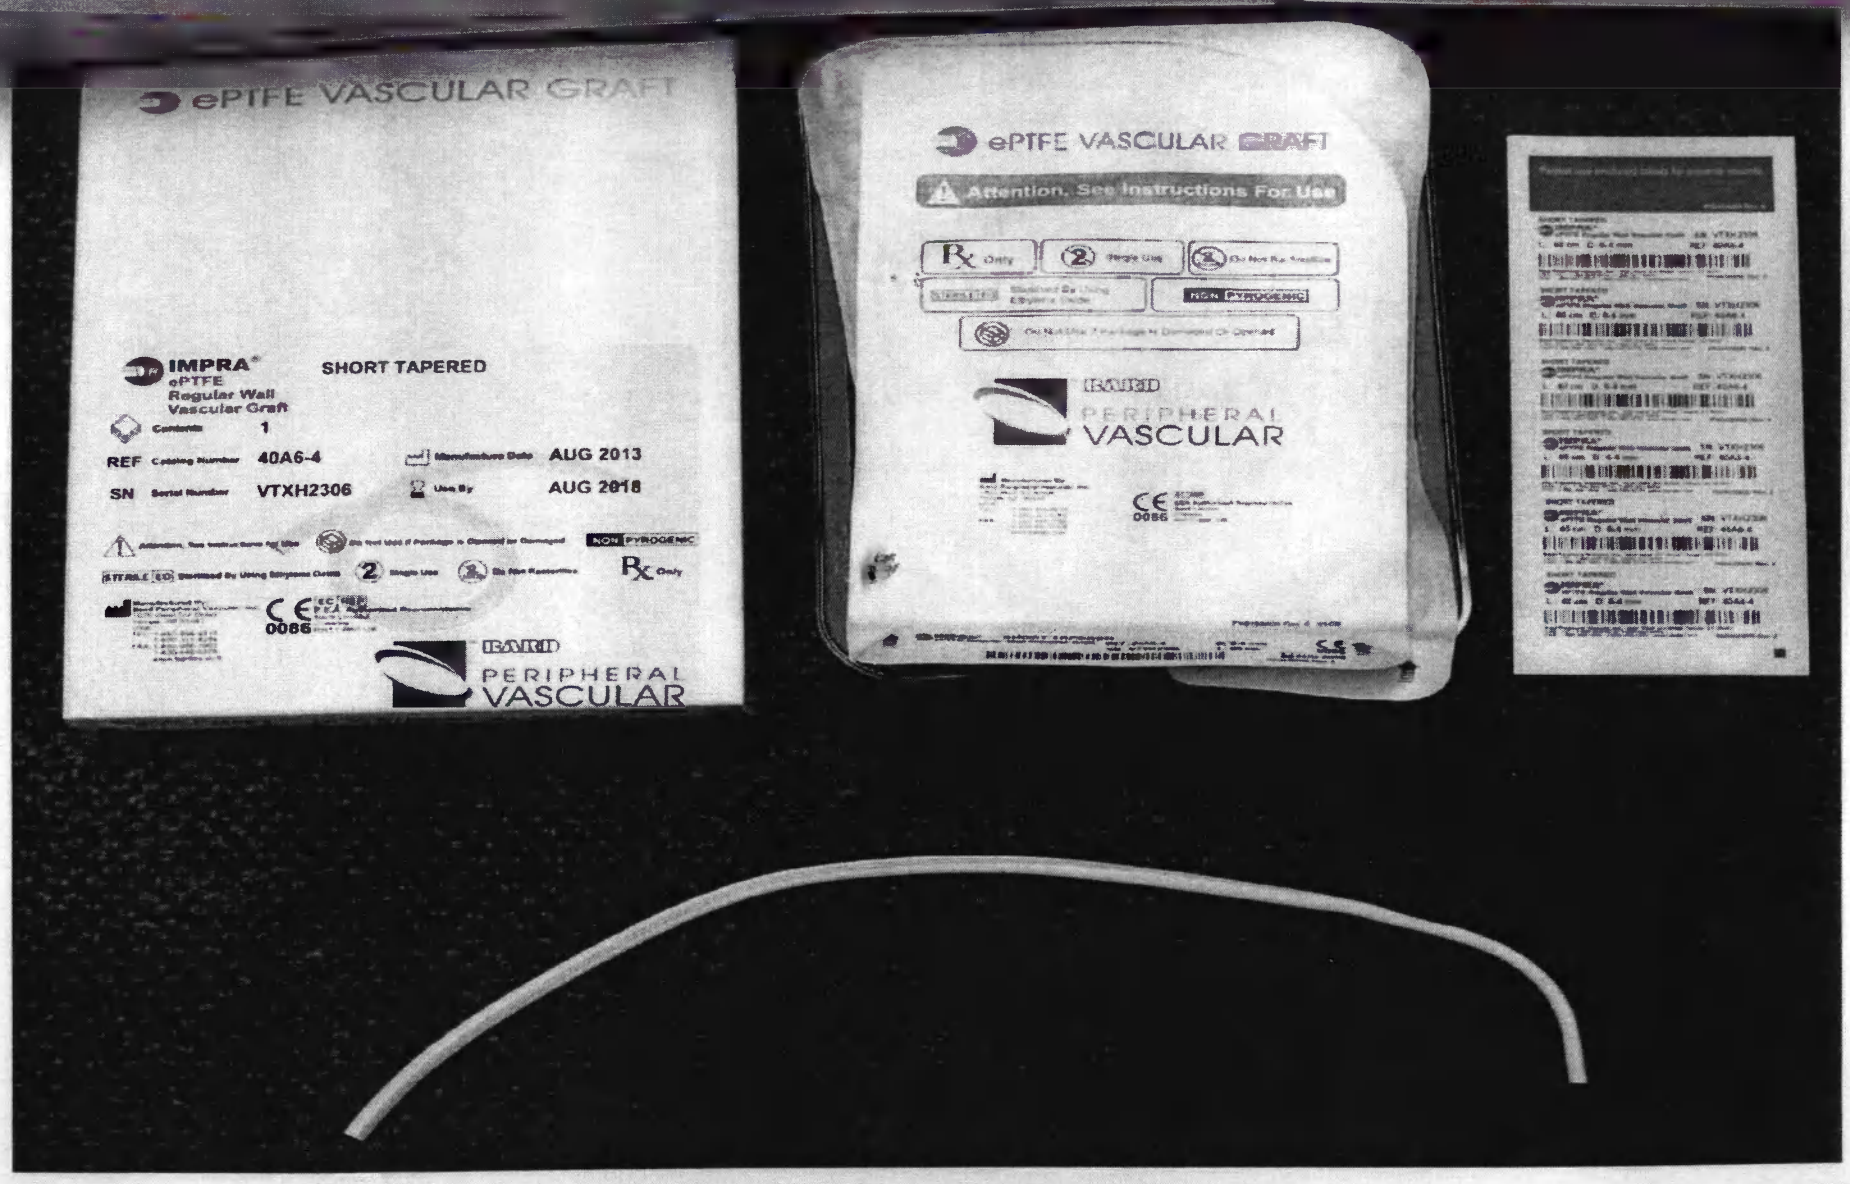

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

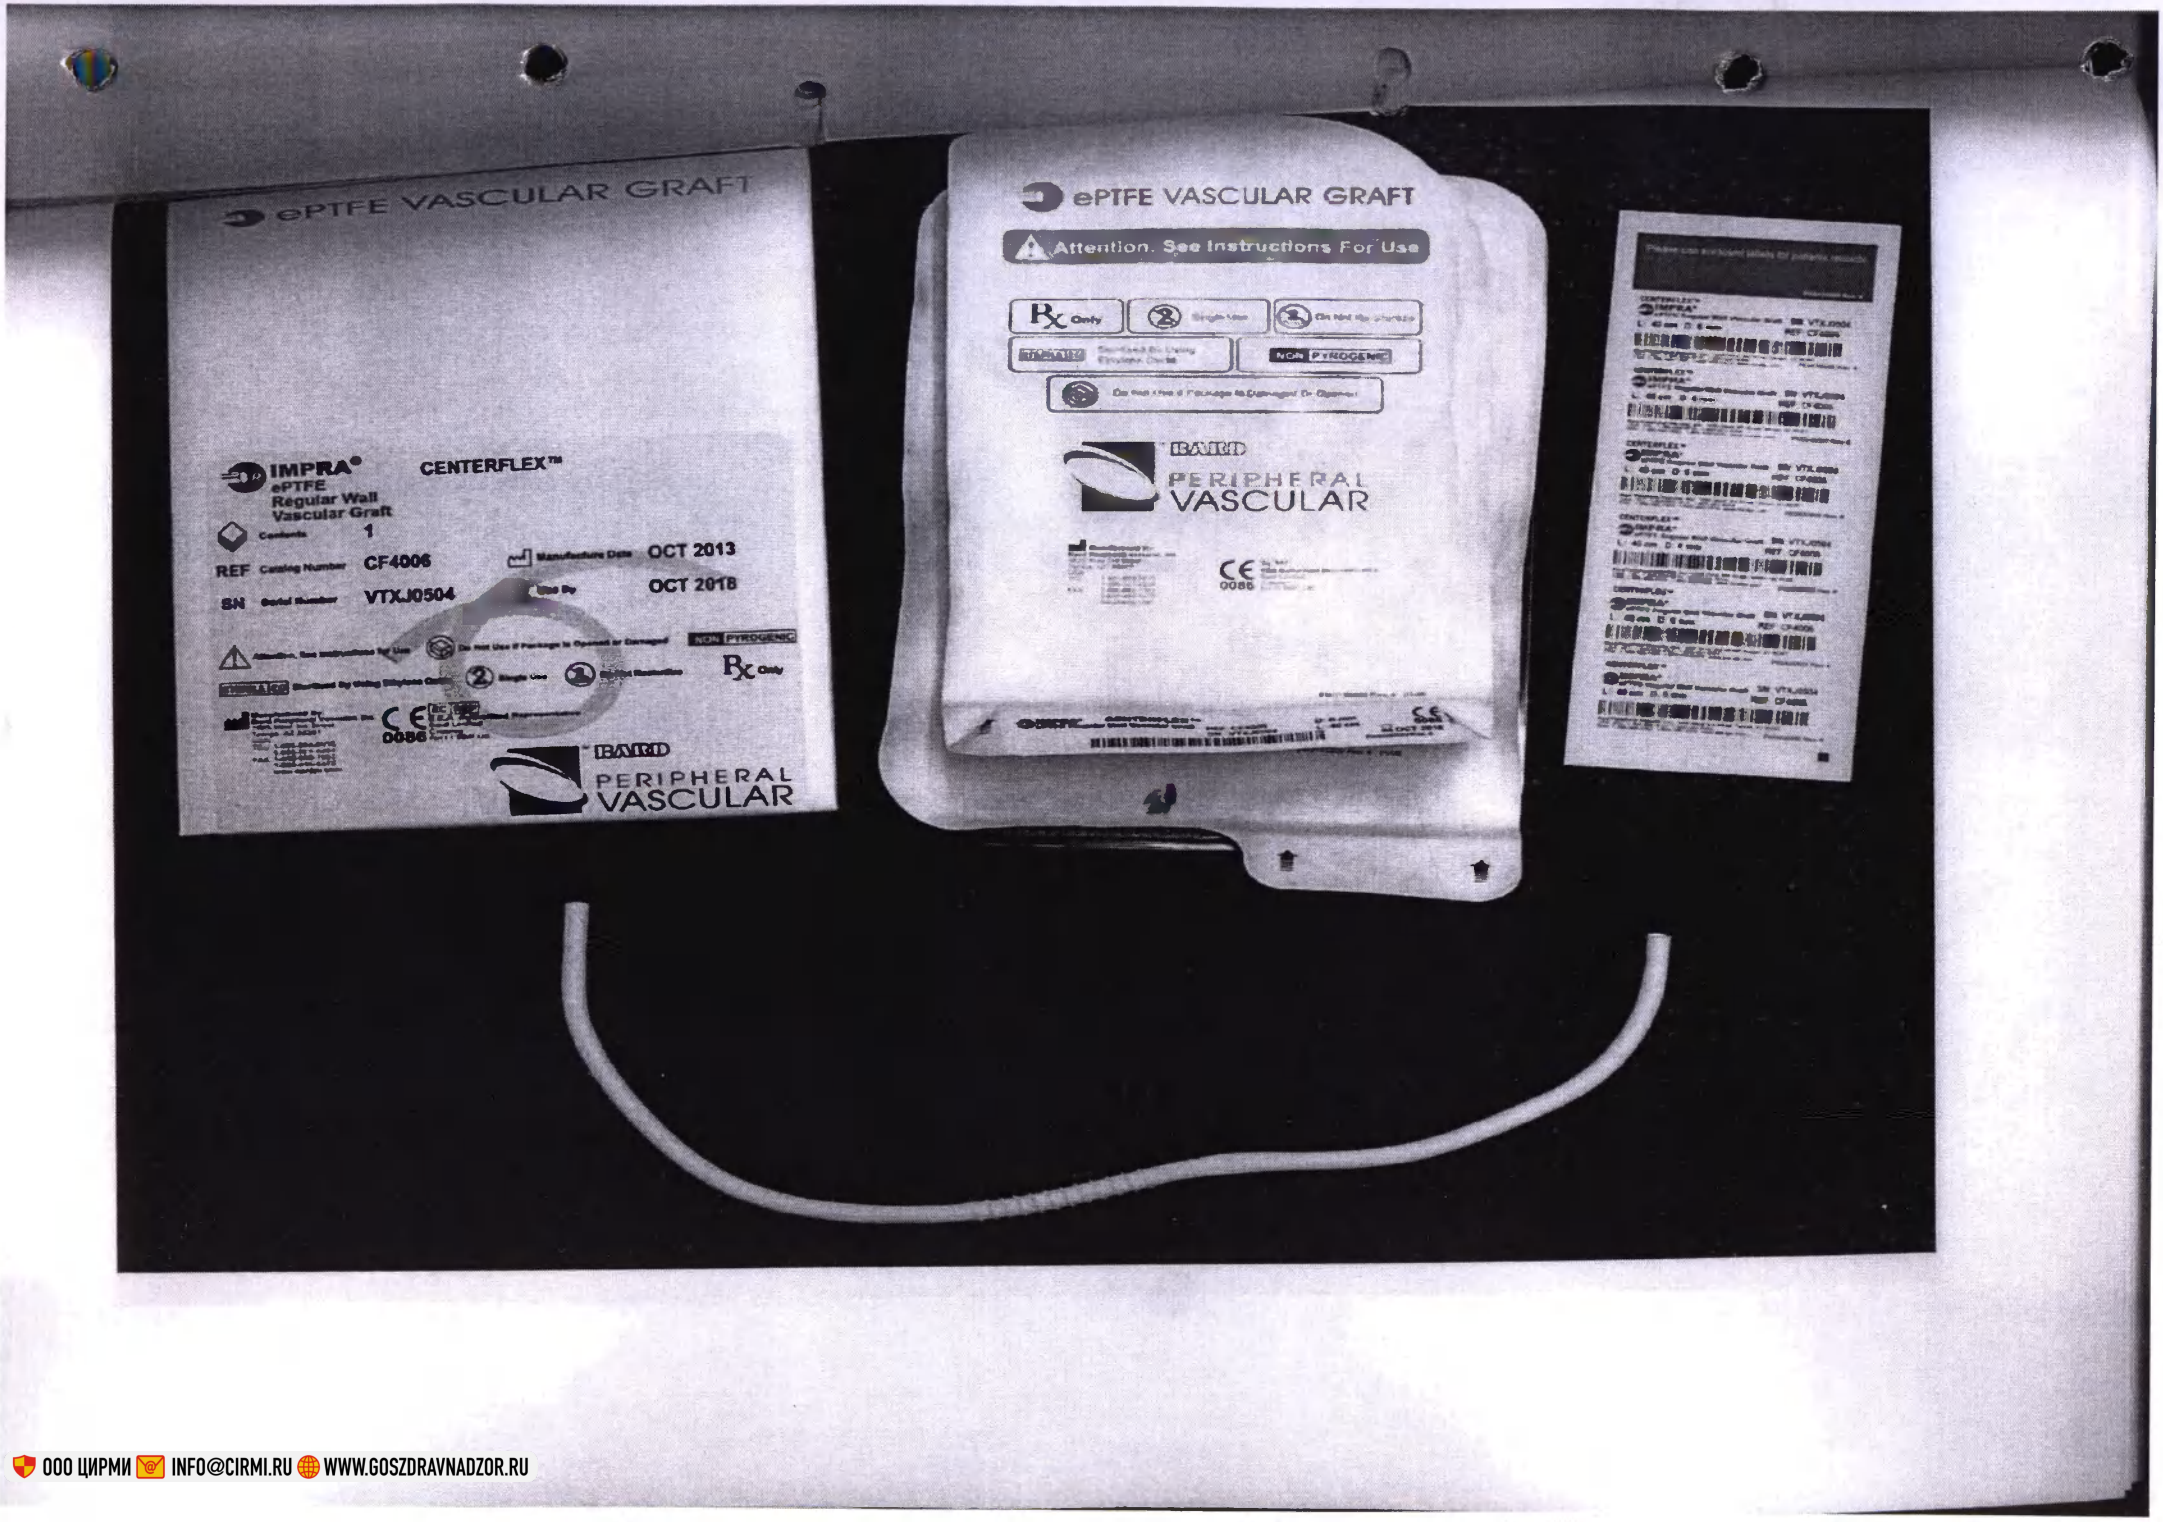

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

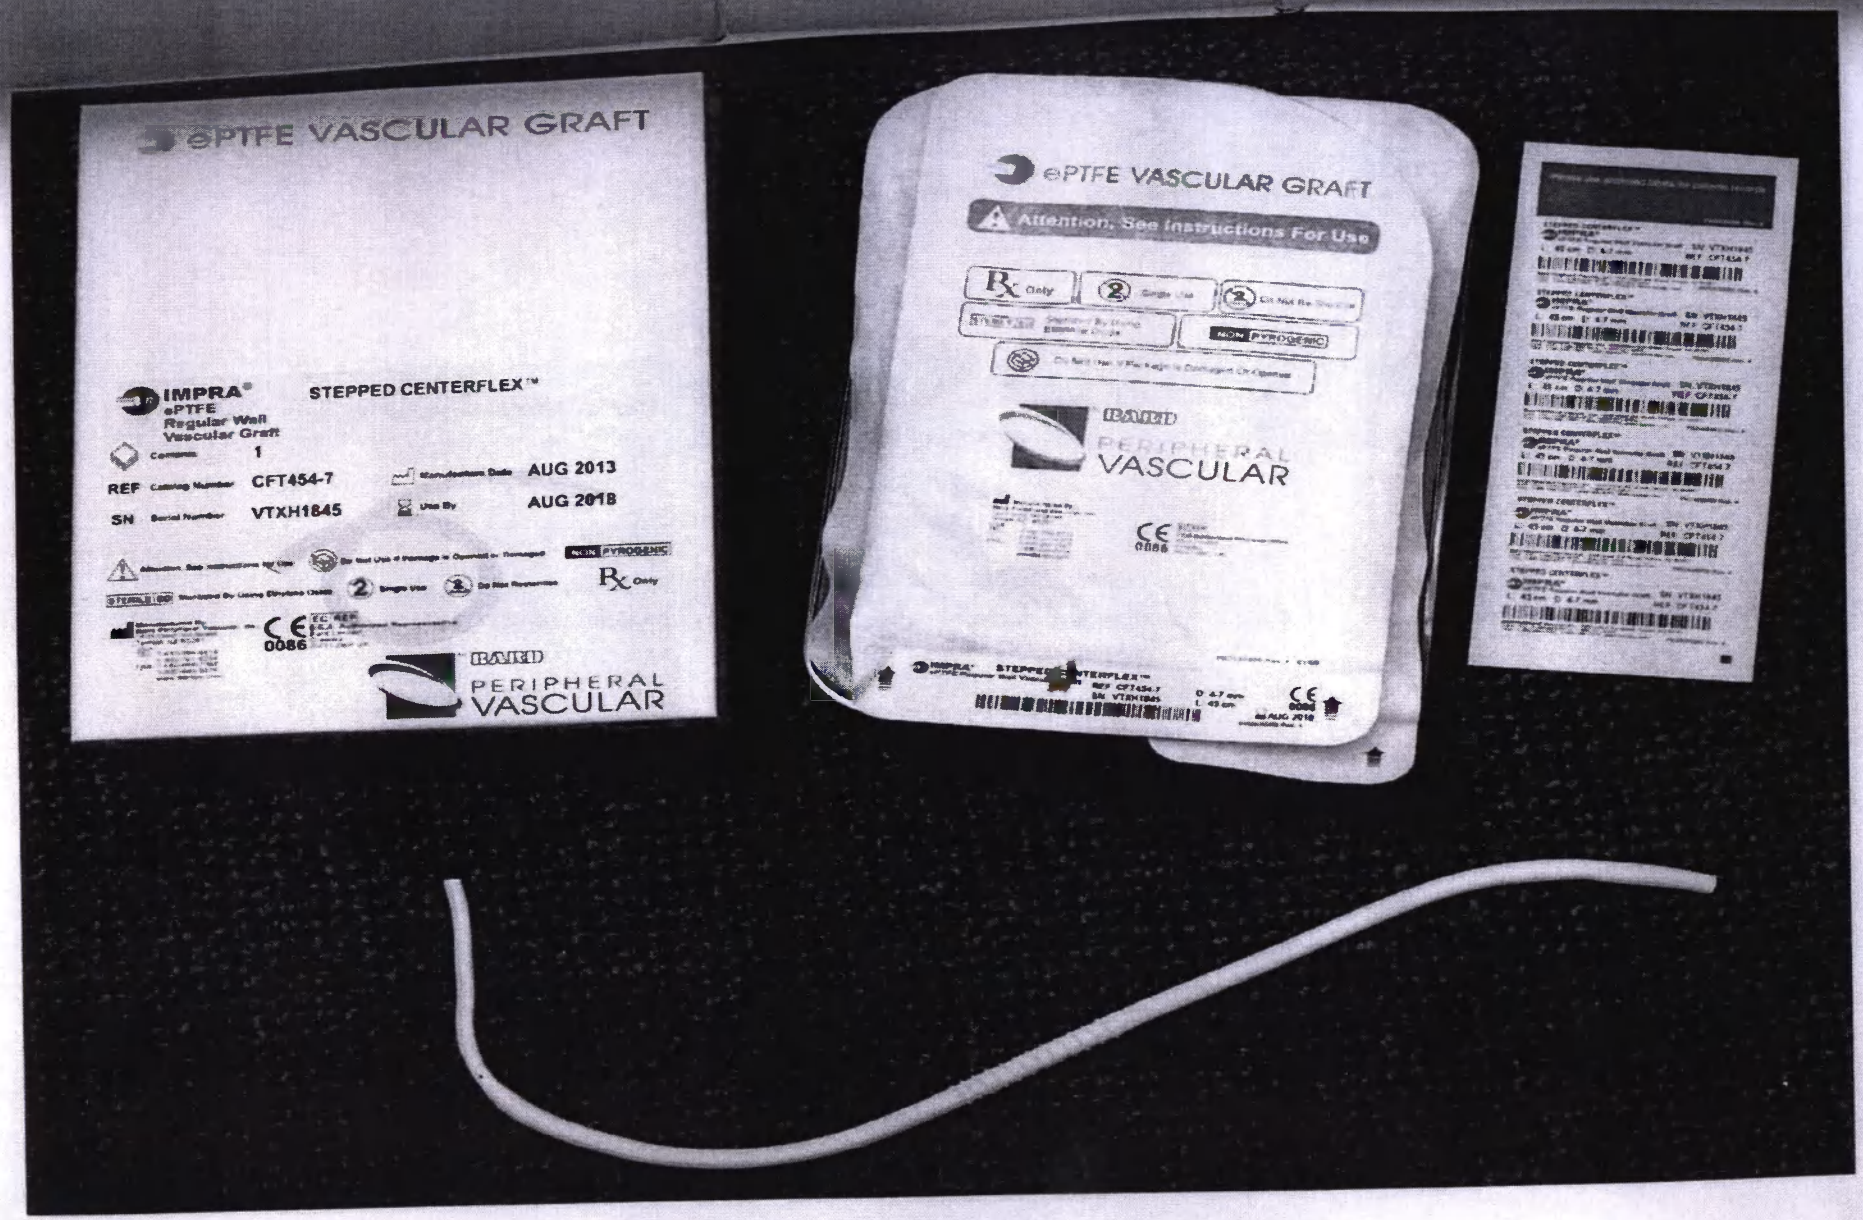

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

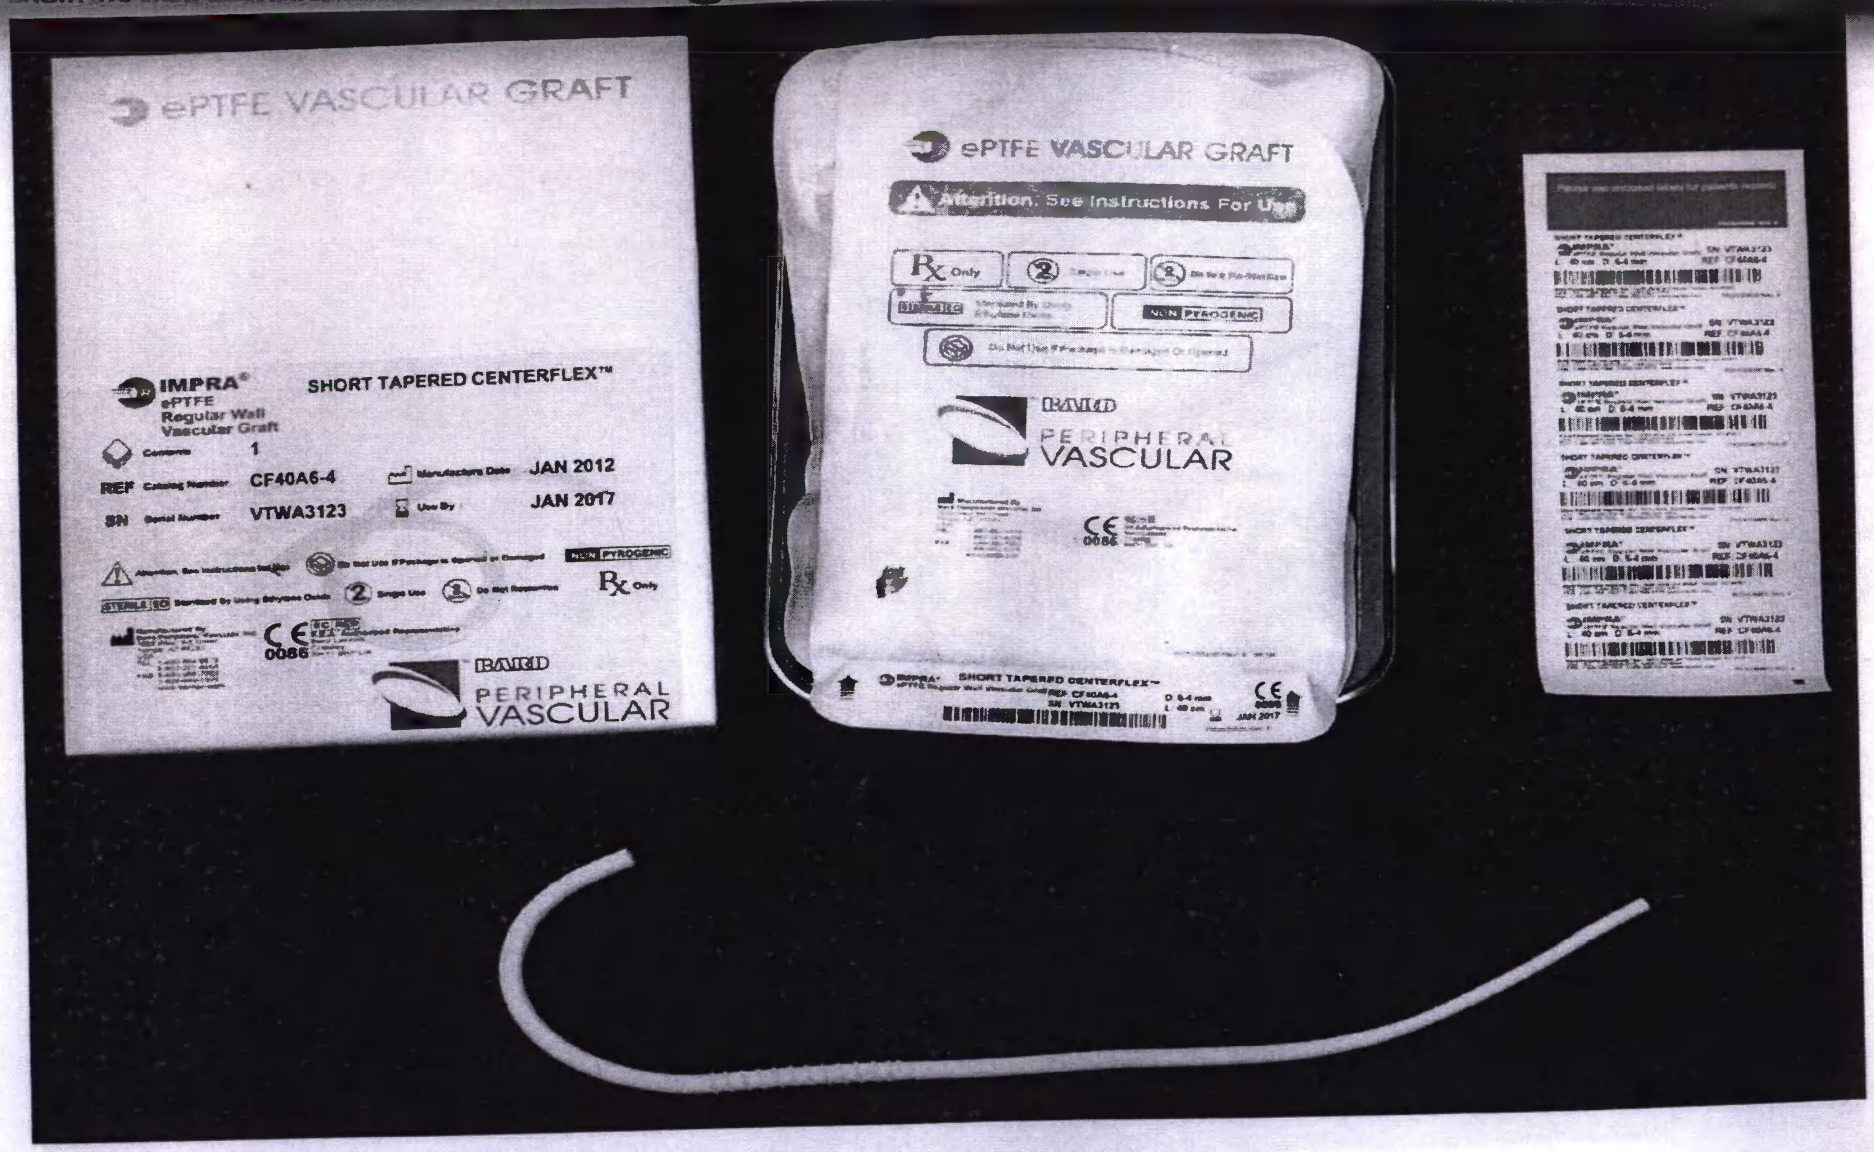

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

IMPRA Carboflo STRAIGHT THINWALL

ePTFE VASCULAR GRAFT

IMPRA
ePTFE Thinwall
Vascular Graft

IMPRA Carboflo®
STRAIGHT THINWALL CARBON-LINED

Contents 1

REF Catalog Number 10S06TWC

Manufacture Date JUL 2013

SN Serial Number VTXG3062

Use By JUL 2018

Attention, See Instructions for Use

Do Not Use If Package is Opened or Damaged

NON PYROGENIC

STERILE EO Sterilized By Using Ethylene Oxide

Single Use

Do Not Resterilize

Rx Only

CE 0086

BAIRD
PERIPHERAL
VASCULAR

ePTFE VASCULAR GRAFT

Attention, See Instructions For Use

Rx Only

Single Use

Do Not Re-Sterilize

STERILE EO Sterilized By Using Ethylene Oxide

NON PYROGENIC

Do Not Use If Package is Damaged Or Opened

BAIRD
PERIPHERAL
VASCULAR

CE 0086

IMPRA Carboflo® STRAIGHT THINWALL CARBON

REF 10S06TWC

SN: VTXG3062

D: 6 mm

L: 10 cm

JUL 2018

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

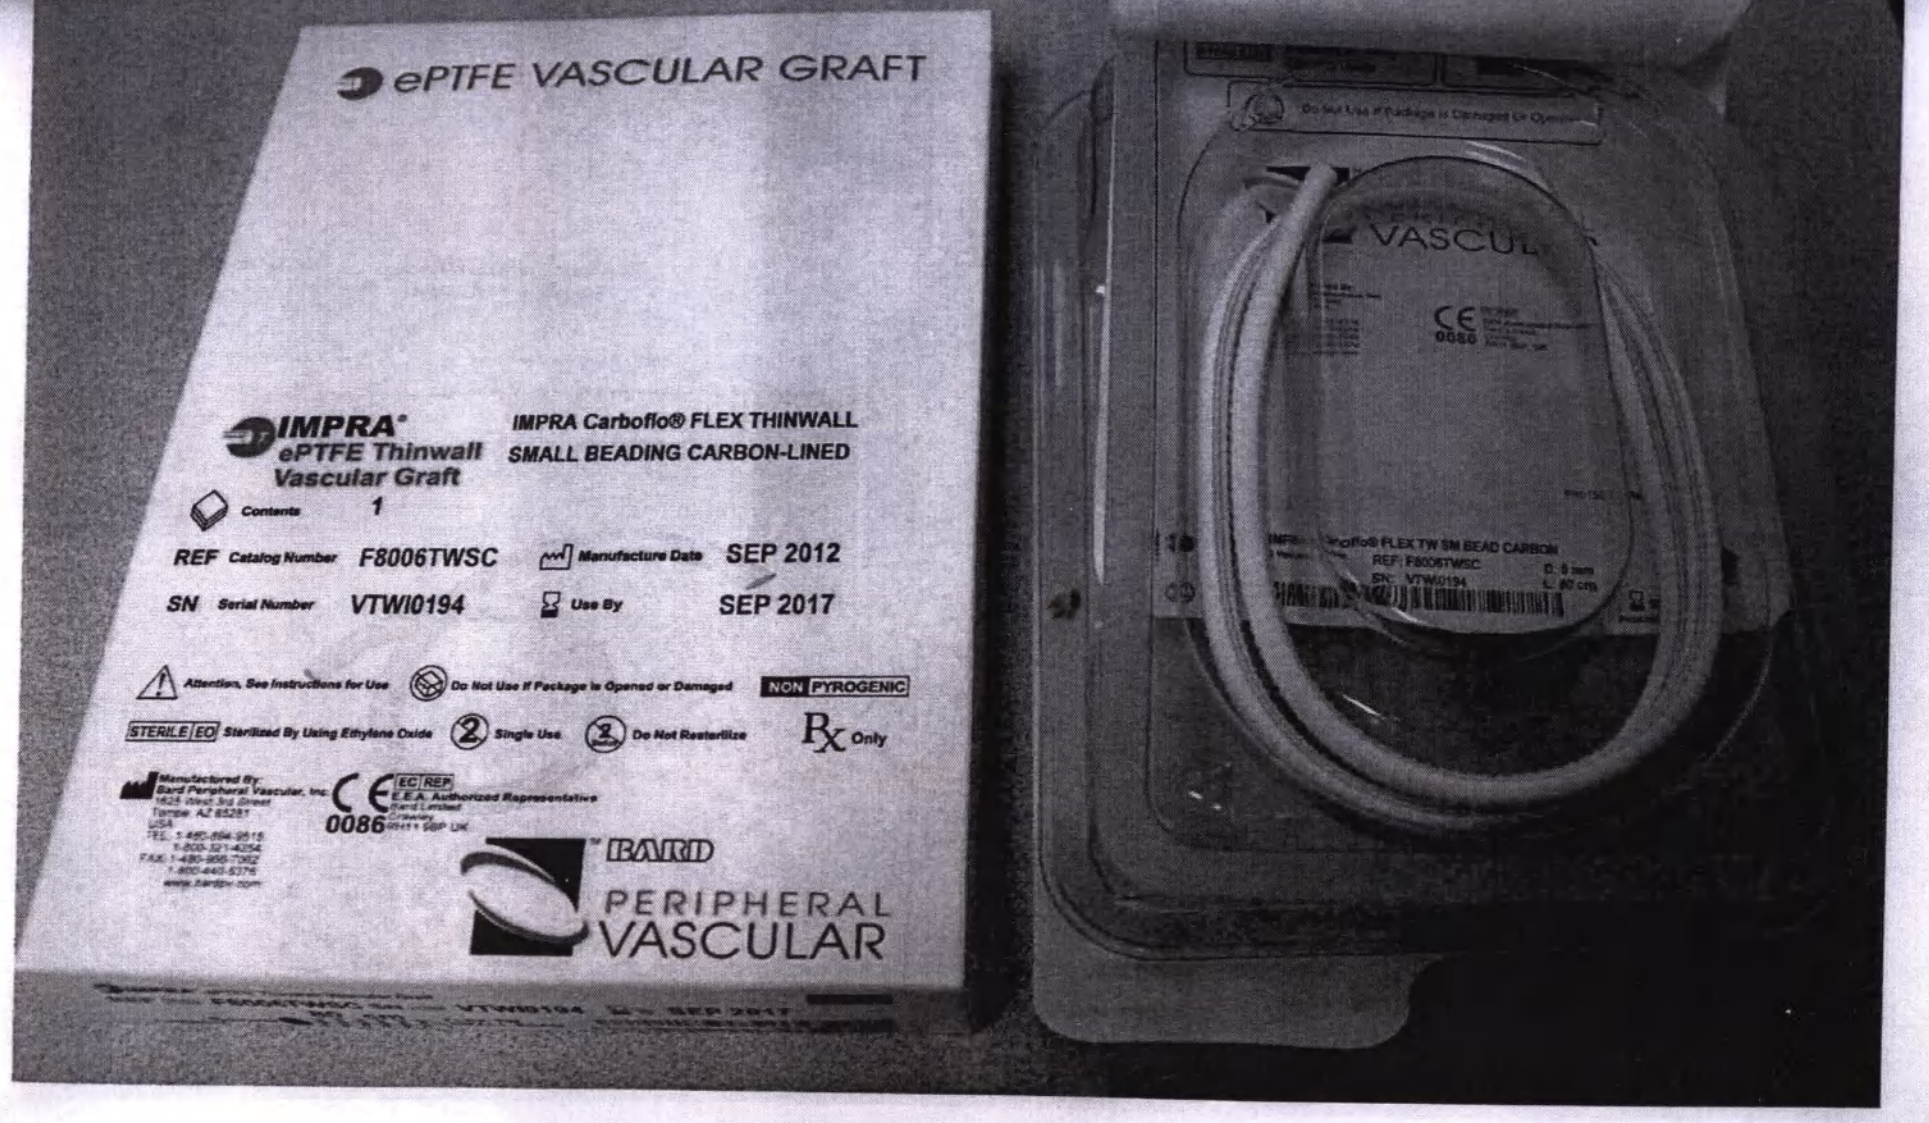

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

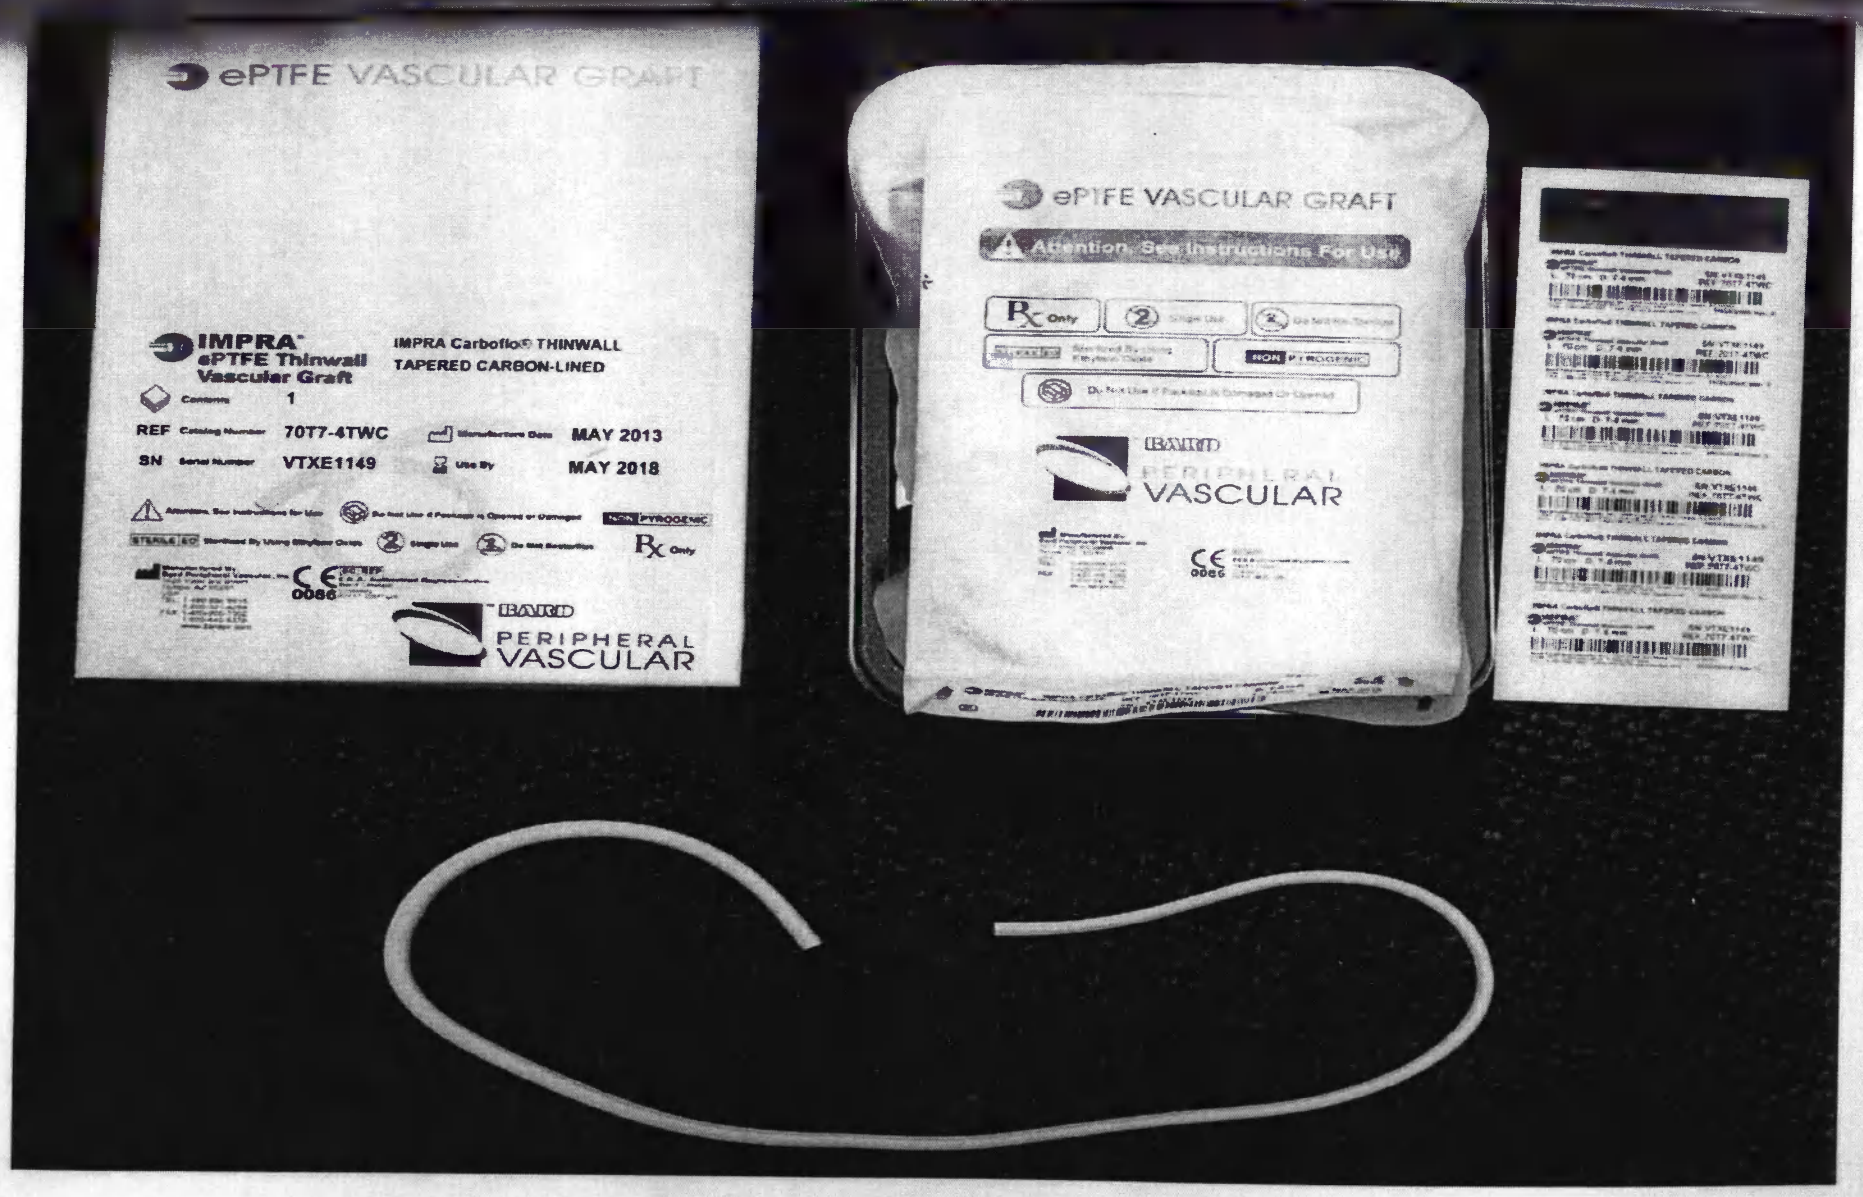

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

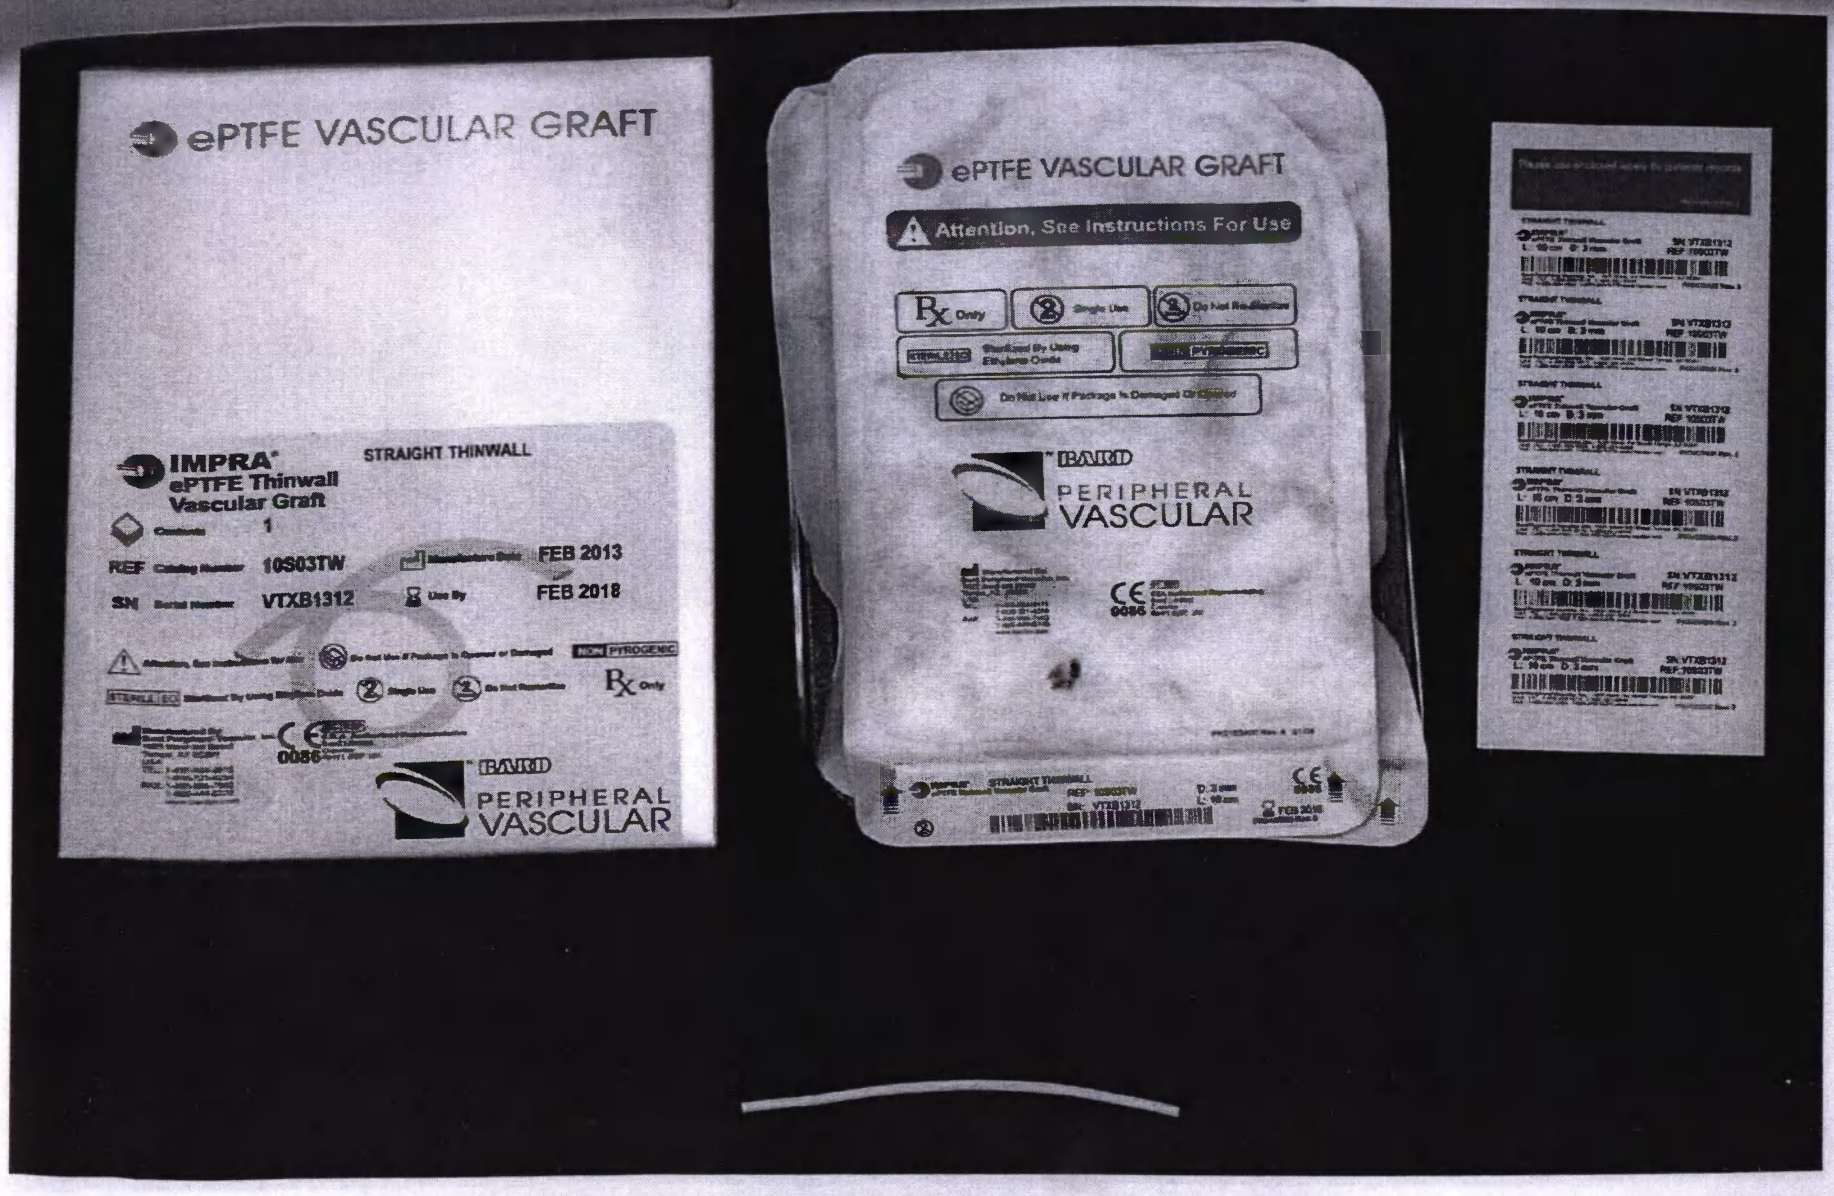

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

IMPRA FLEX THINWALL TAPERED SMALL

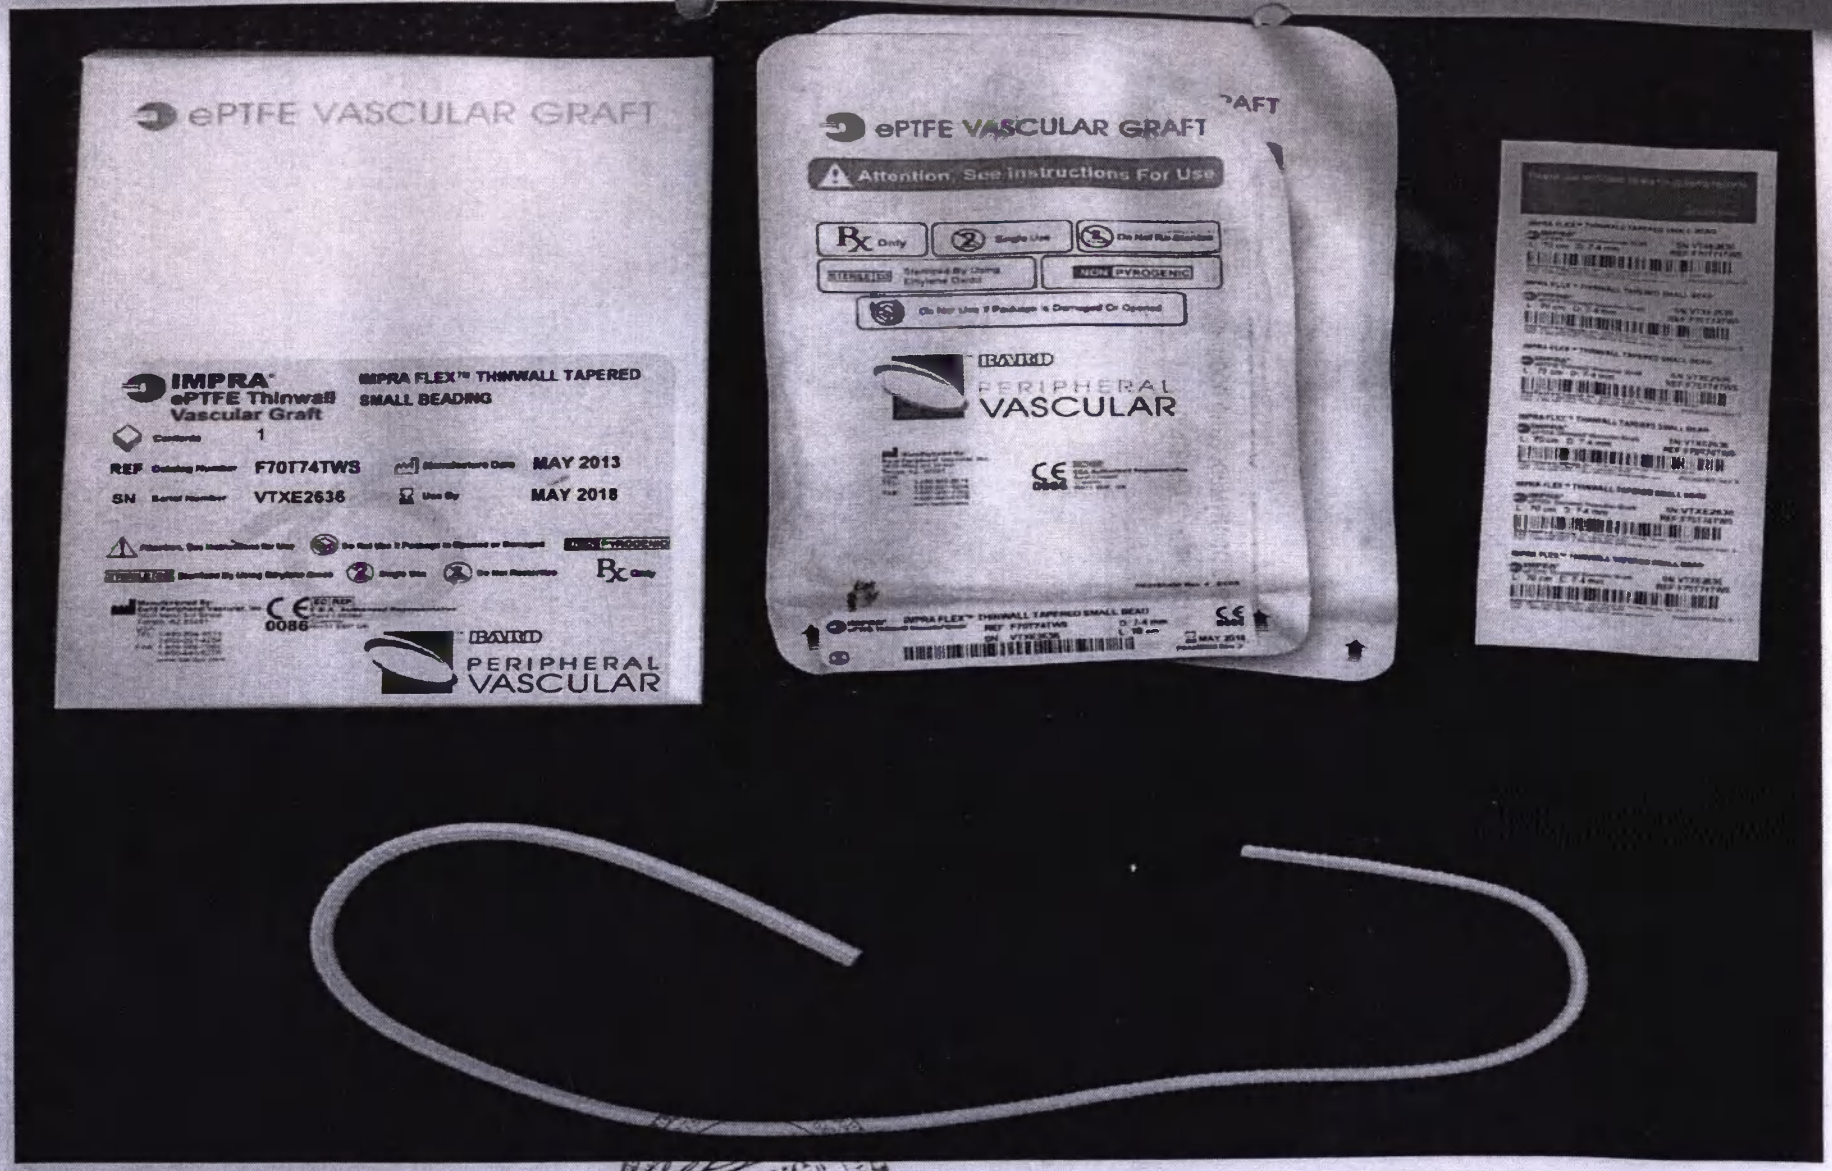

Генеральный директор ООО «Бард Рус» _____ В. П. Мариевский

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Всего пронумеровано прошнуровано
и скреплено печатью -31-
-тридцать один- л(-а;ов)

«Бард РУС»
LLC Bard RUS

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU