


Фотографические изображения
медицинского изделия

Томограф магнитно-резонансный SIGNA Premier с принадлежностями

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель отдела Регистрации и сертификации
Россия и СНГ

ООО «ДжиИ Хэлскеа»



А.П. Харитонова

« 21 » 06

2022 г.



GE Medical Systems, LLC



**3200 N Grandview Blvd
Waukesha, WI 53188 USA**



SIGNA Premier



CE 0197



2019-06



**GE MEDICAL SYSTEMS SCS
283 RUE DE LA MINIERE
78530 BUC FRANCE**



Томограф магнитно-резонансный SIGNA Premier с принадлежностями (общий вид)




1. Магнит с активным экранированием и встроенной РЧ-катушкой



1. Магнит с активным экранированием и встроенной РЧ-катушкой




2. Магнит с активным экранированием и встроенной РЧ-катушкой

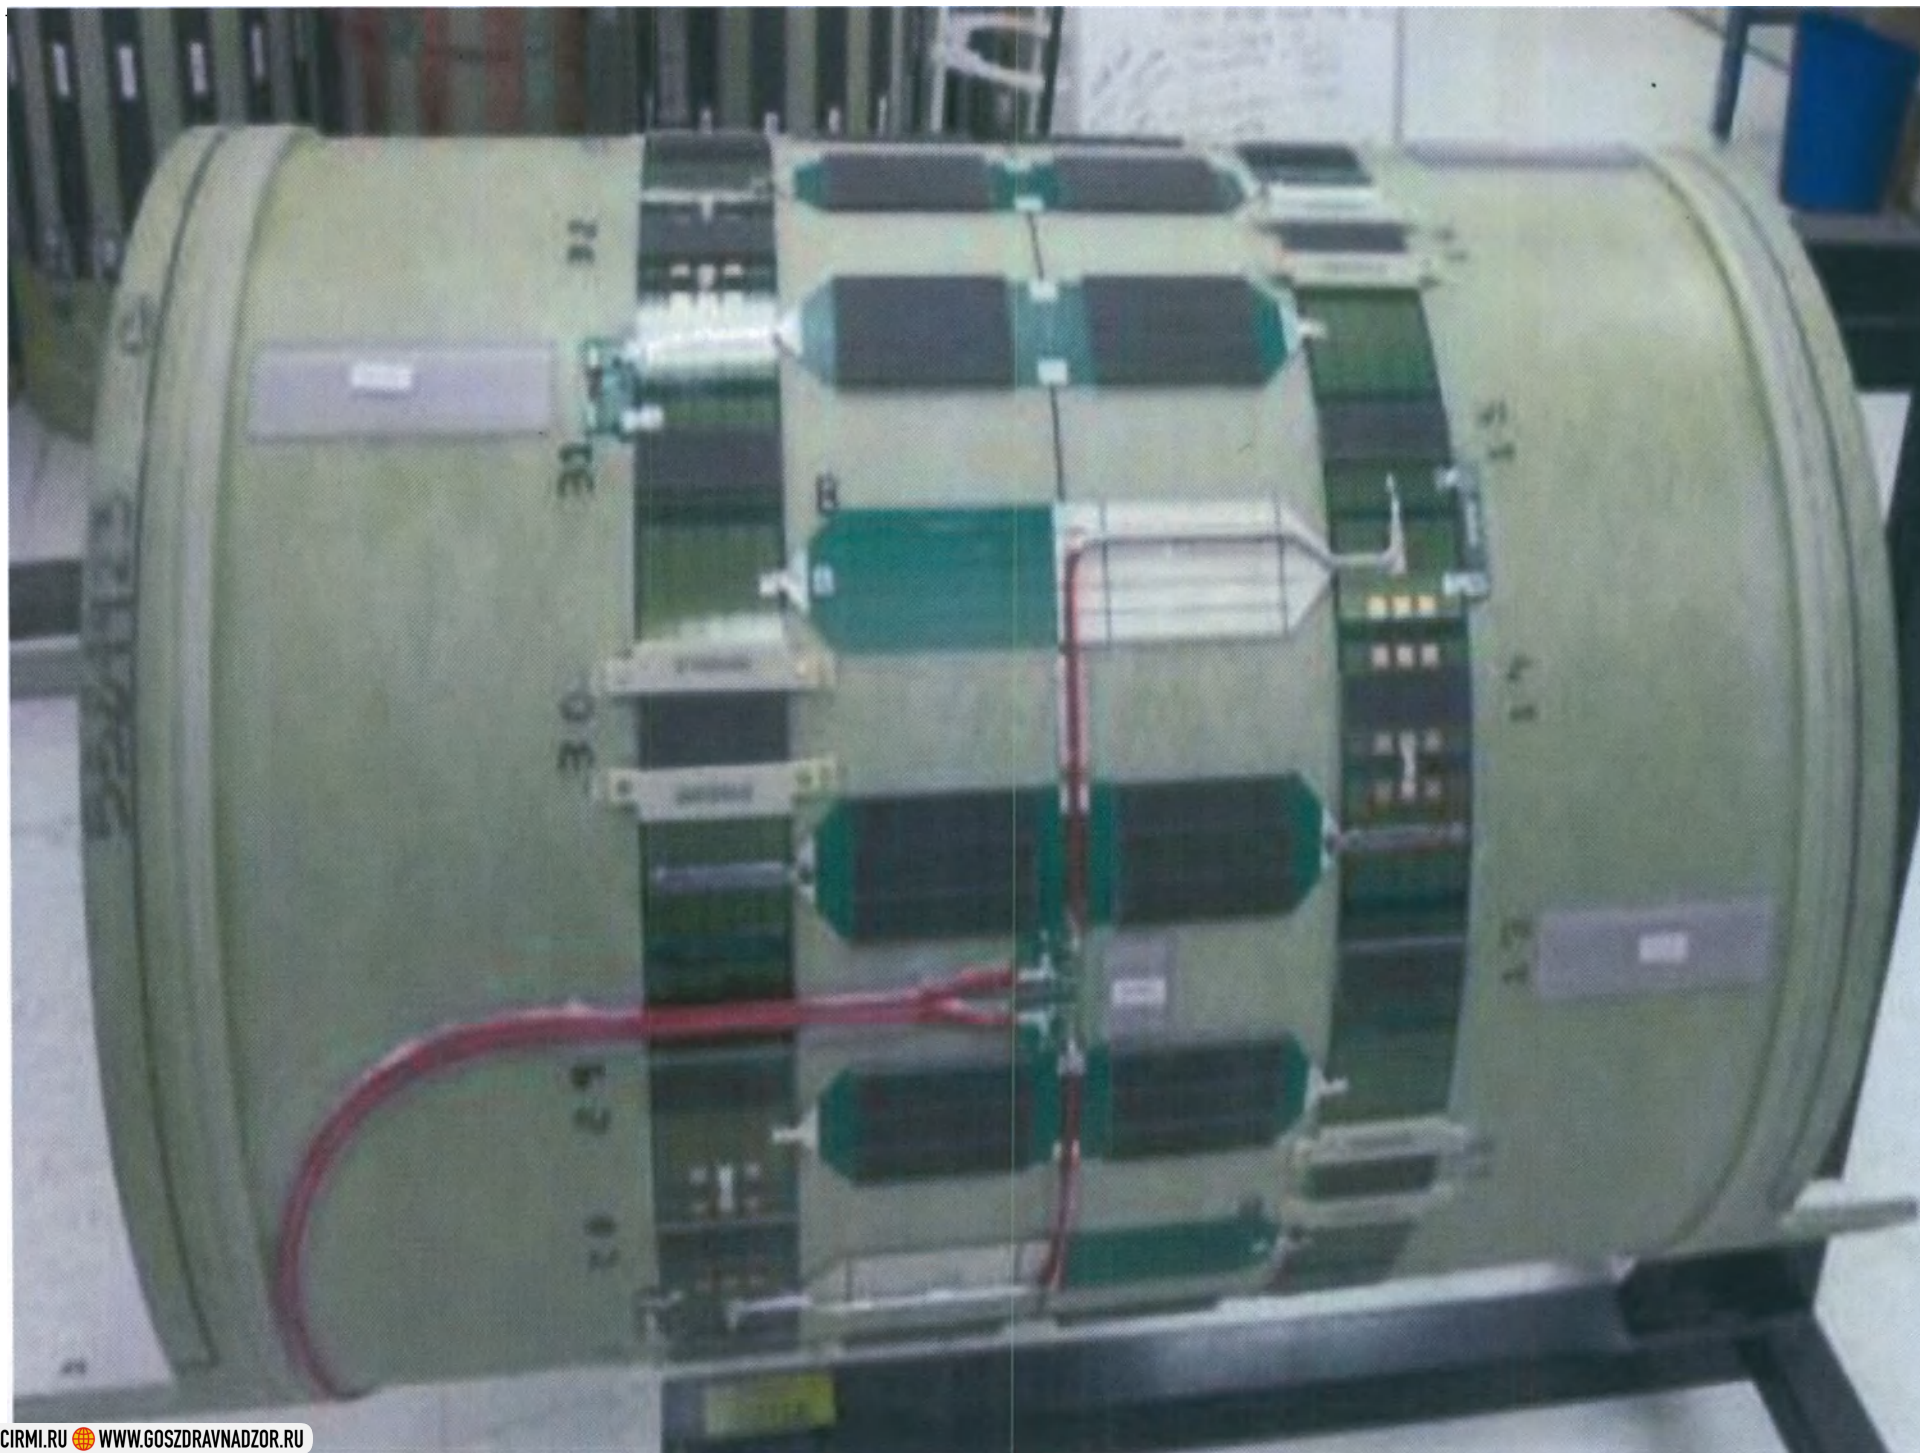

2. Консоль оператора




2. Консоль оператора

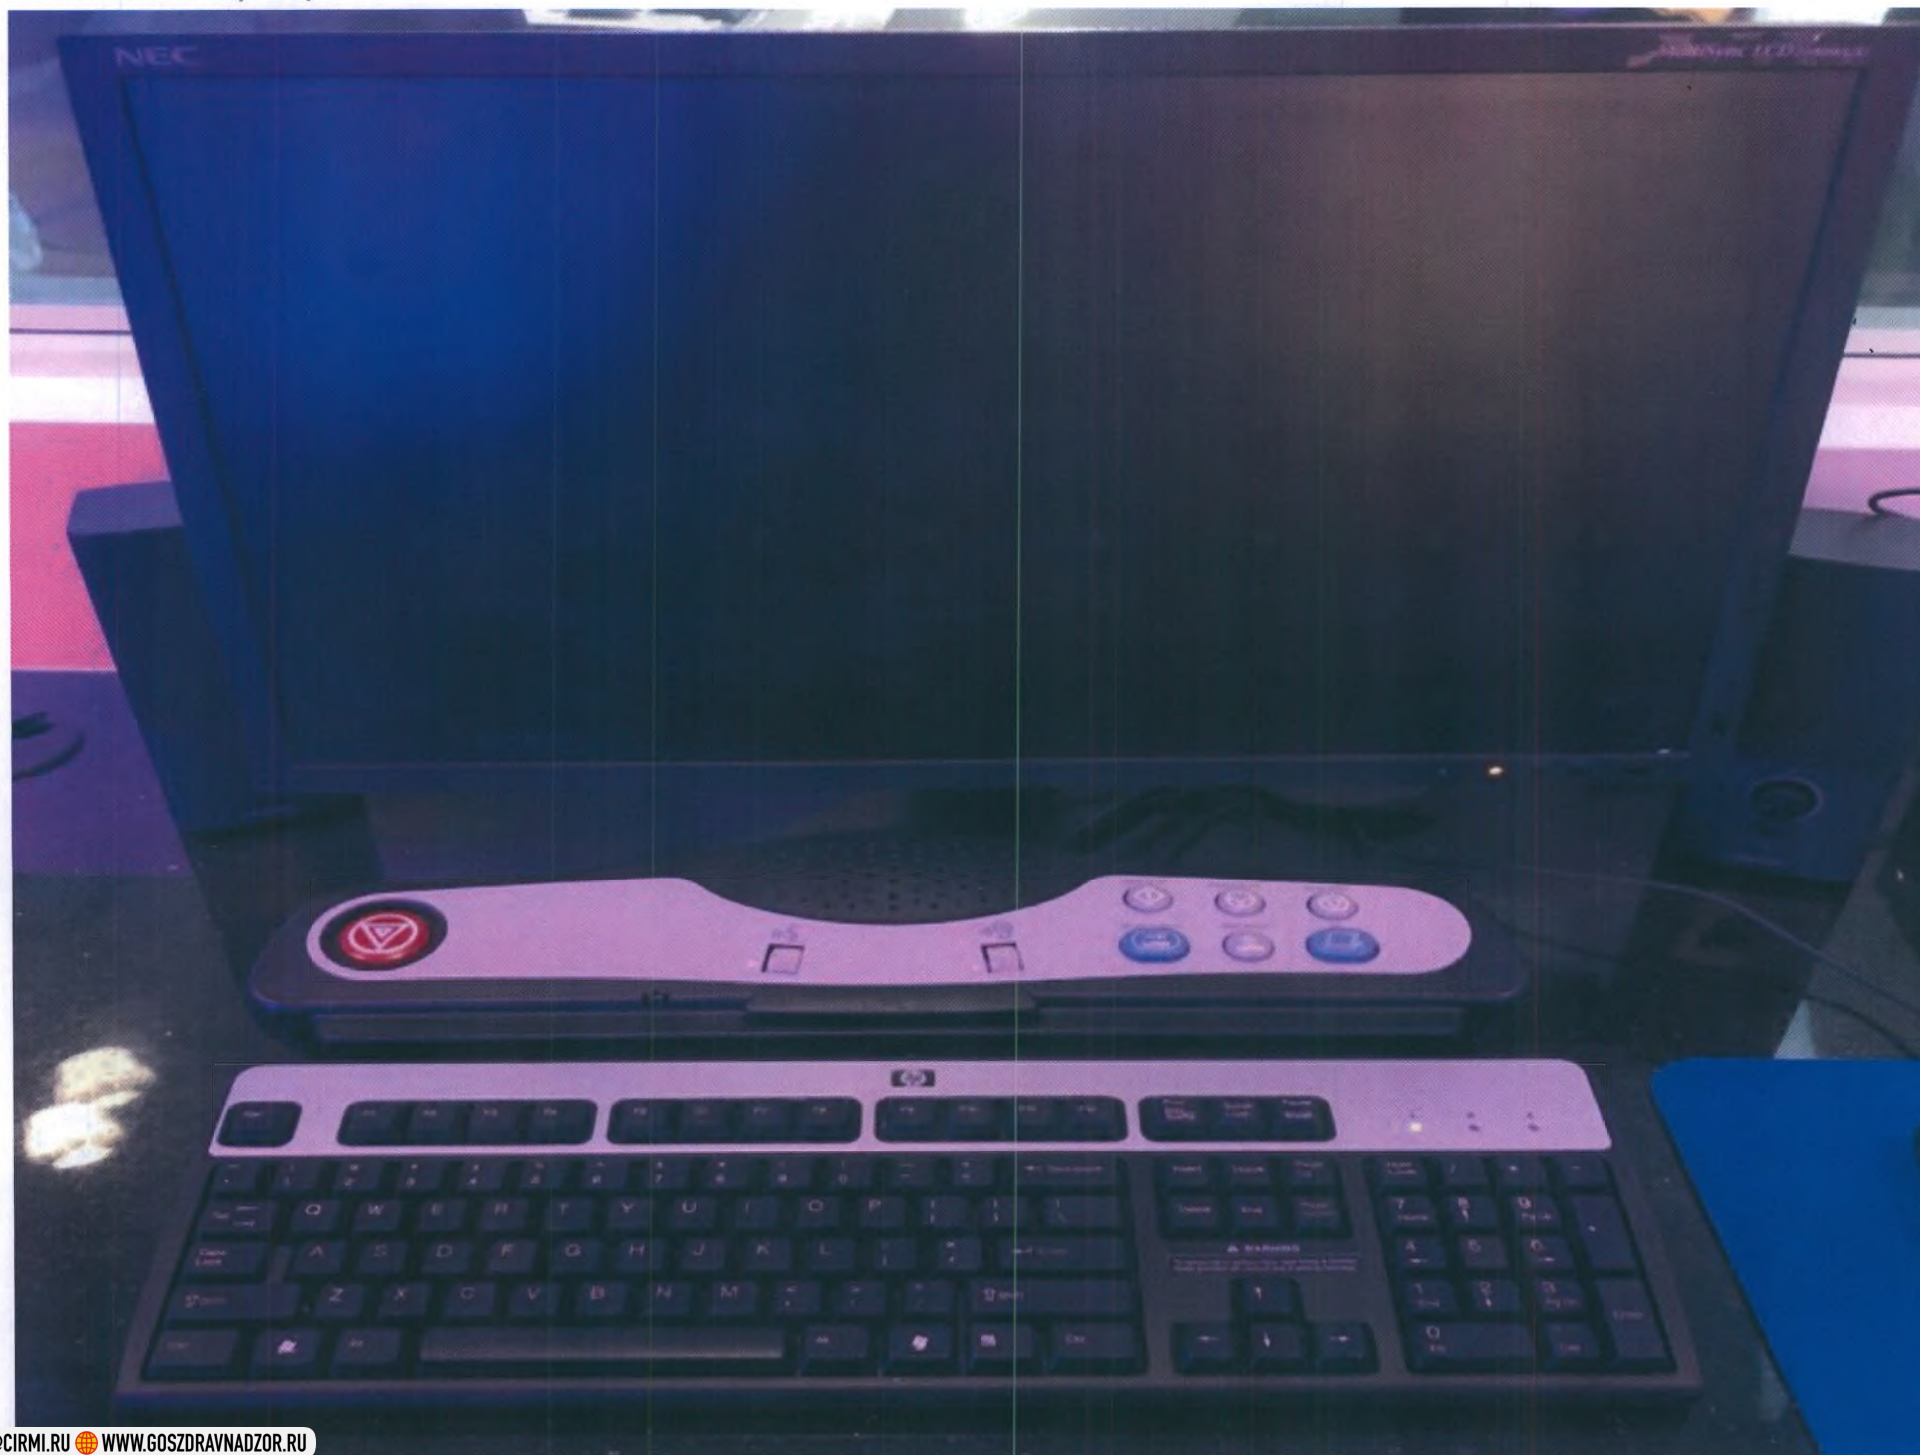


2. Консоль оператора



3. Стол пациента

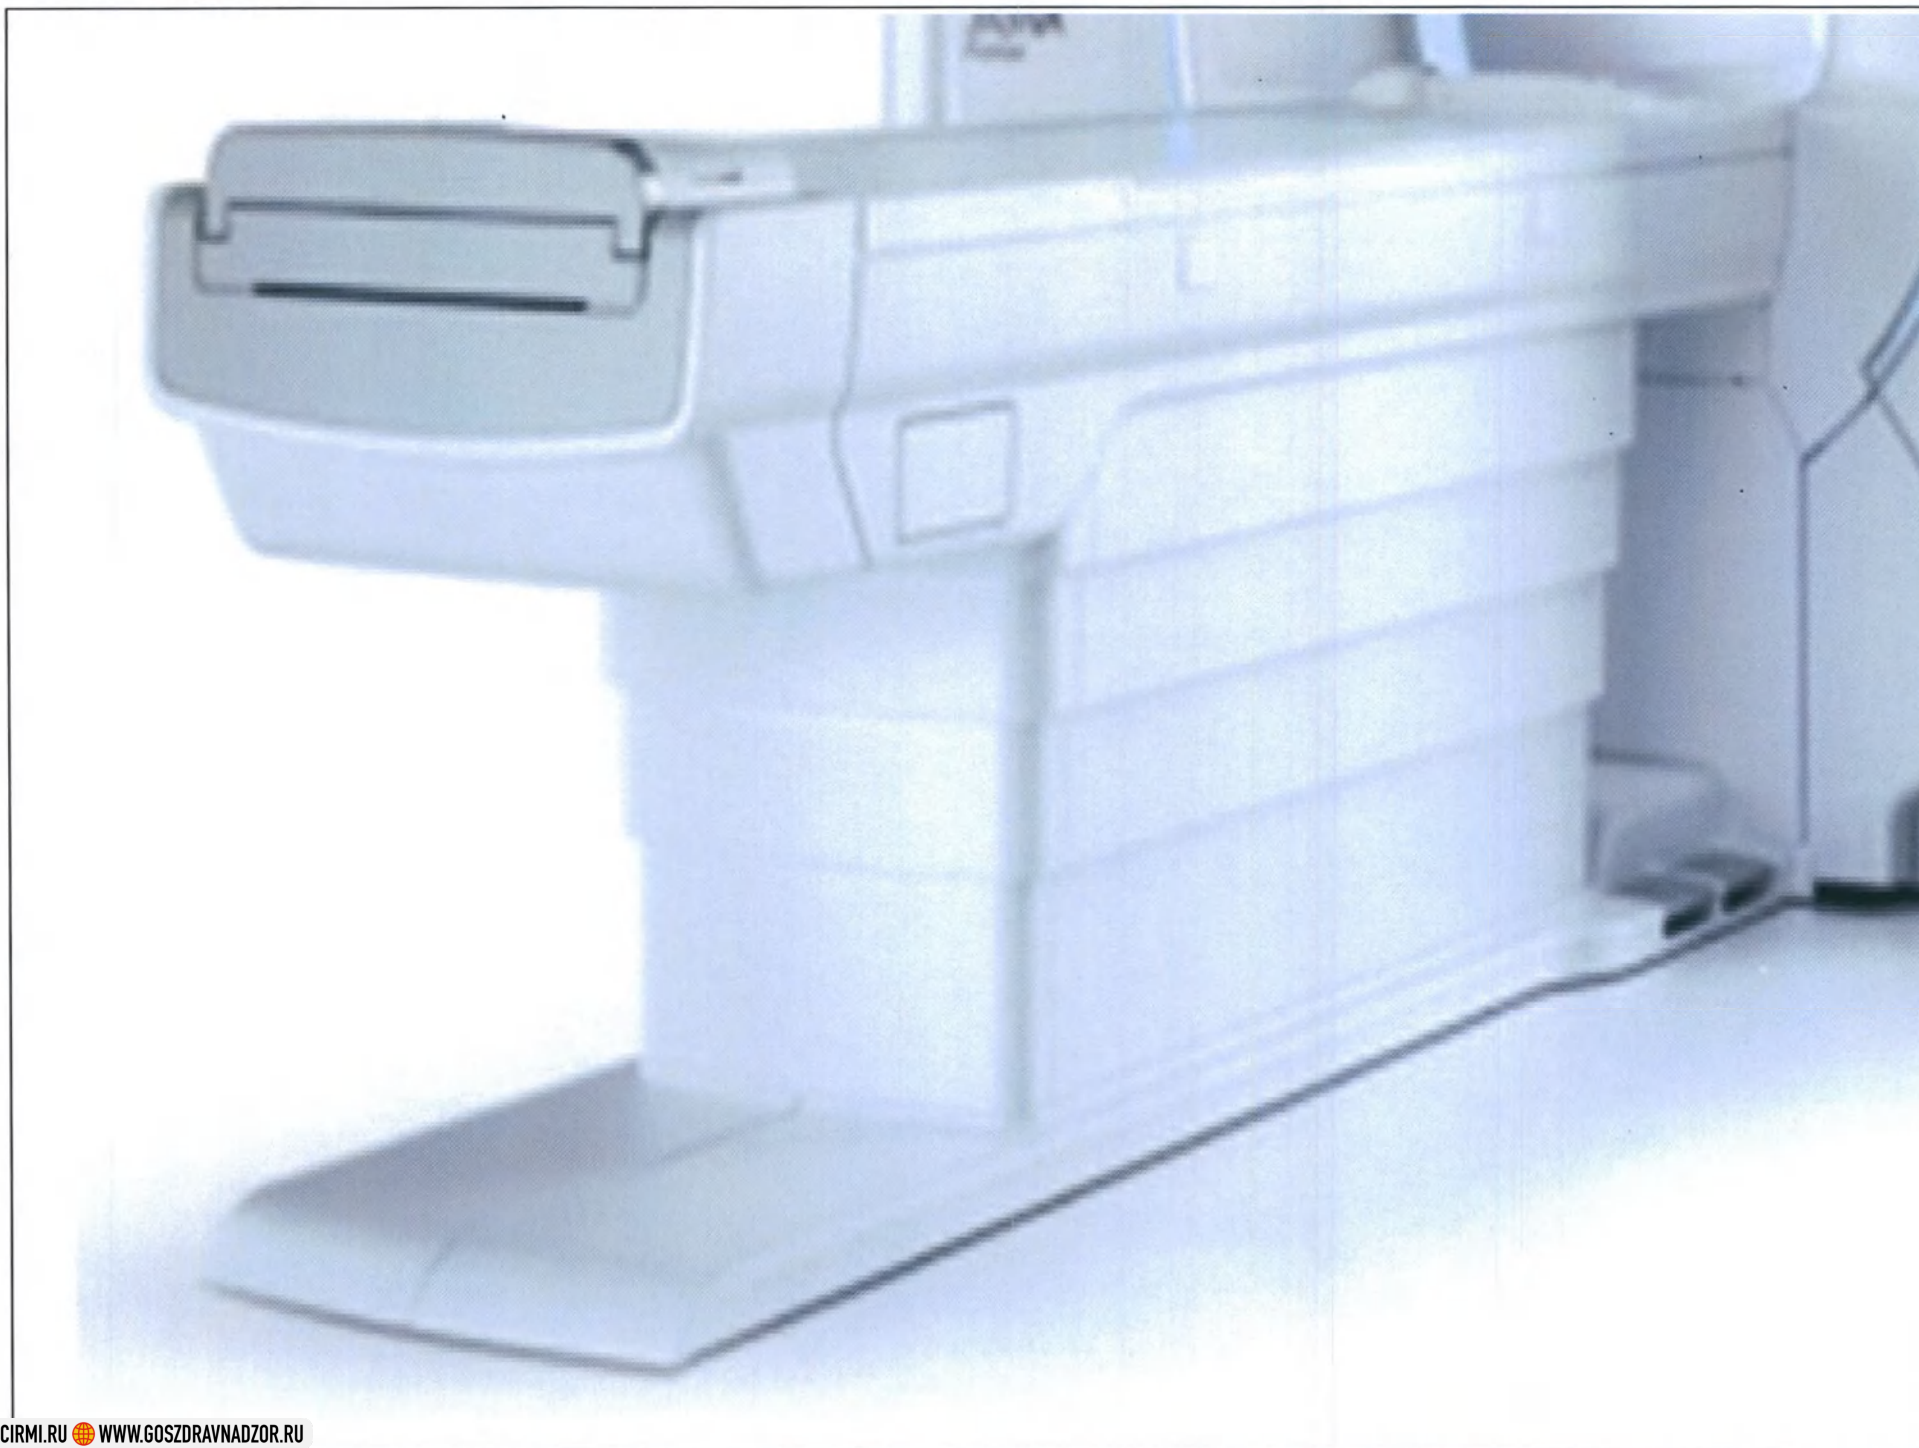

3. Стол пациента

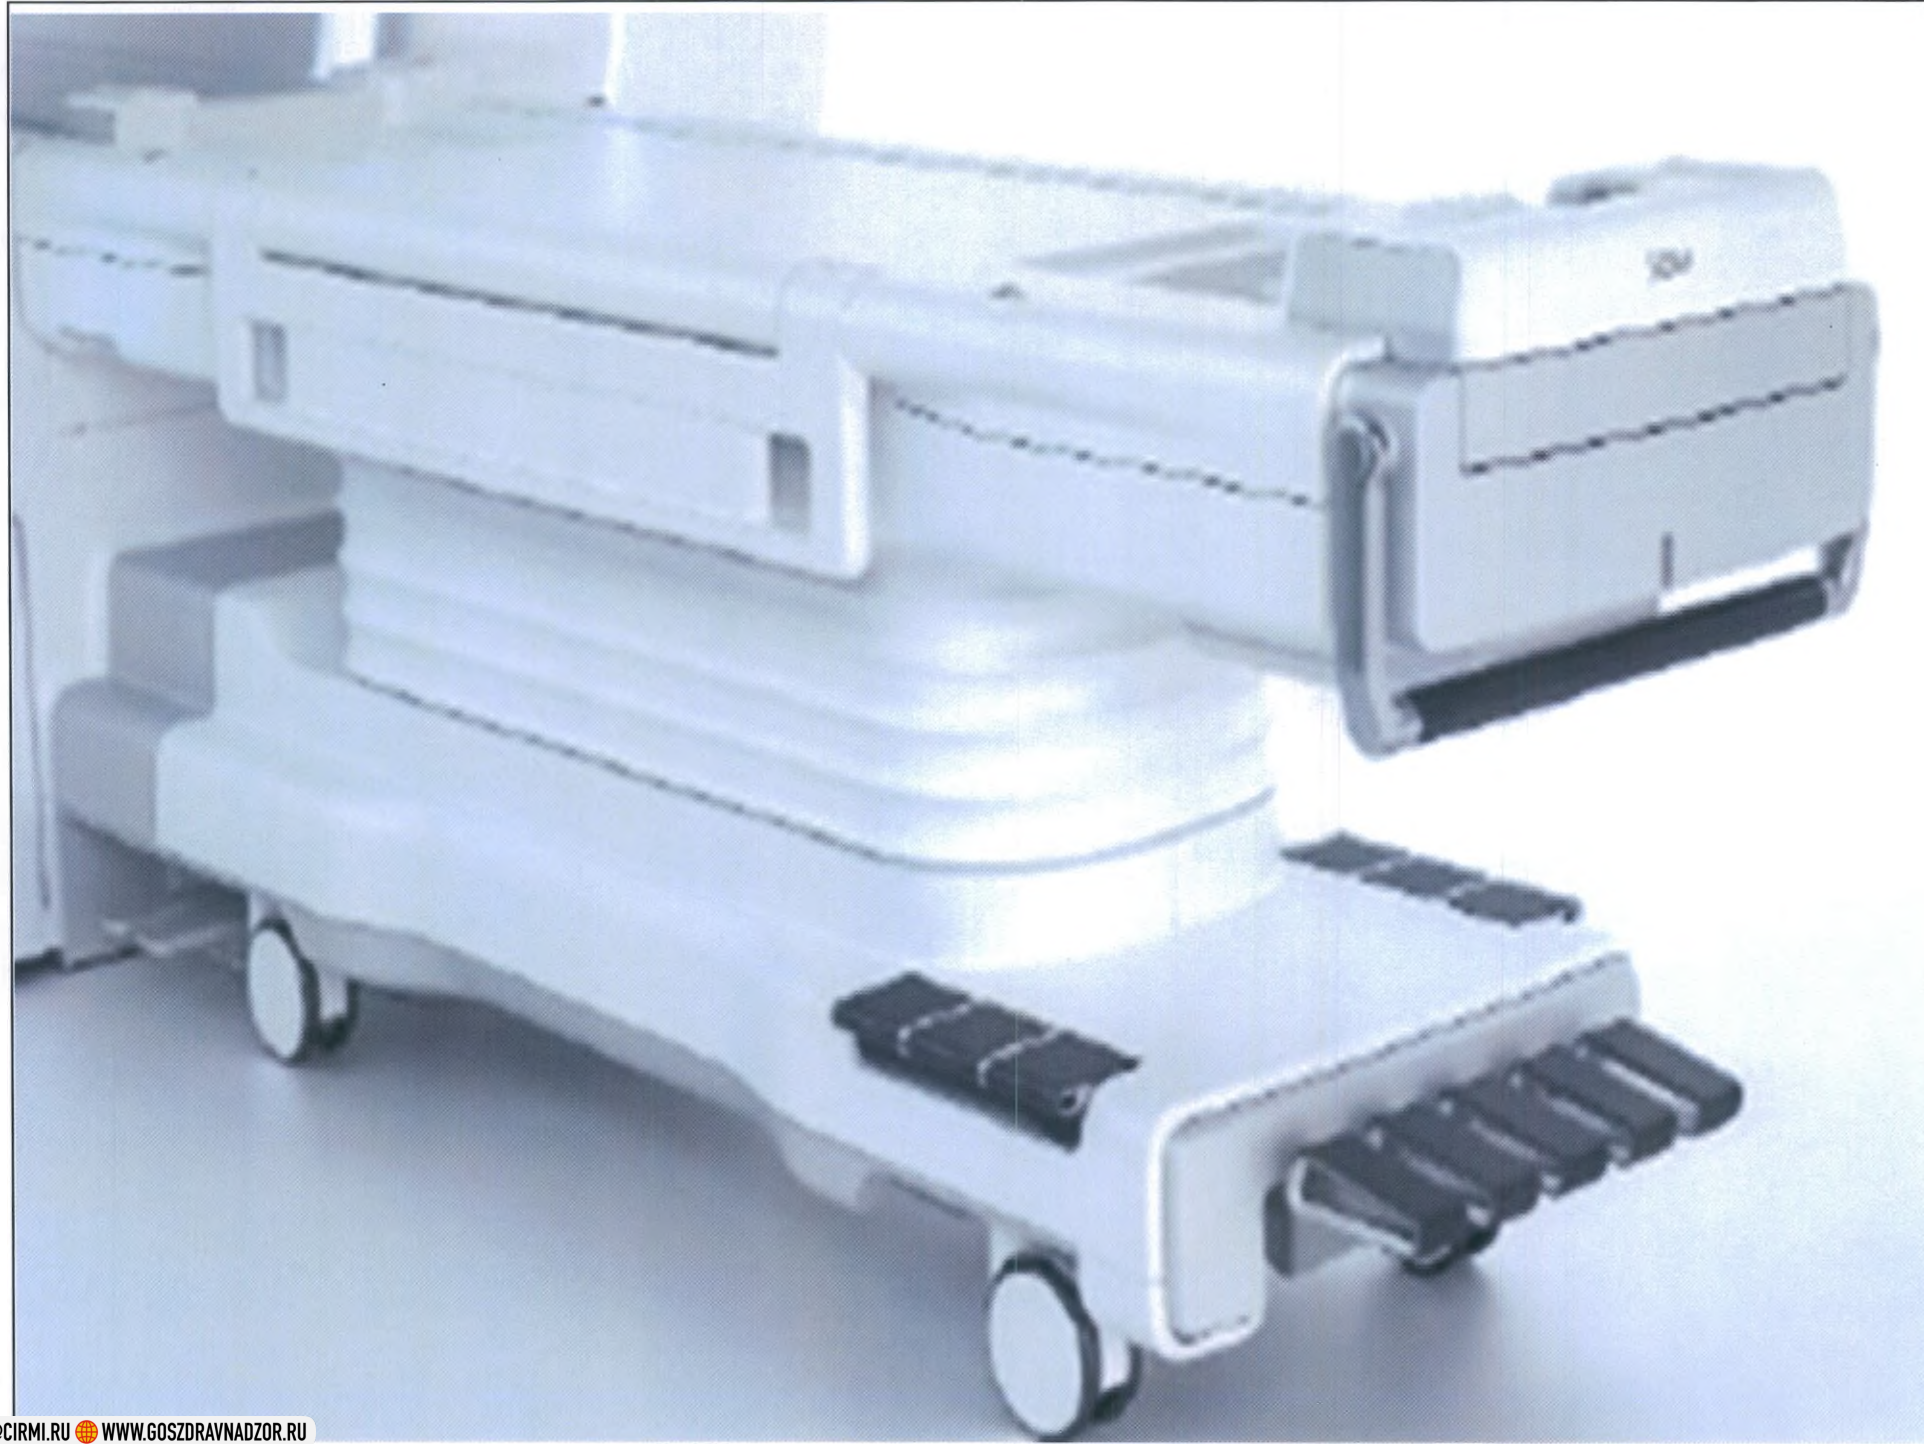


3. Стол пациента



3. Стол пациента




3. Стол пациента

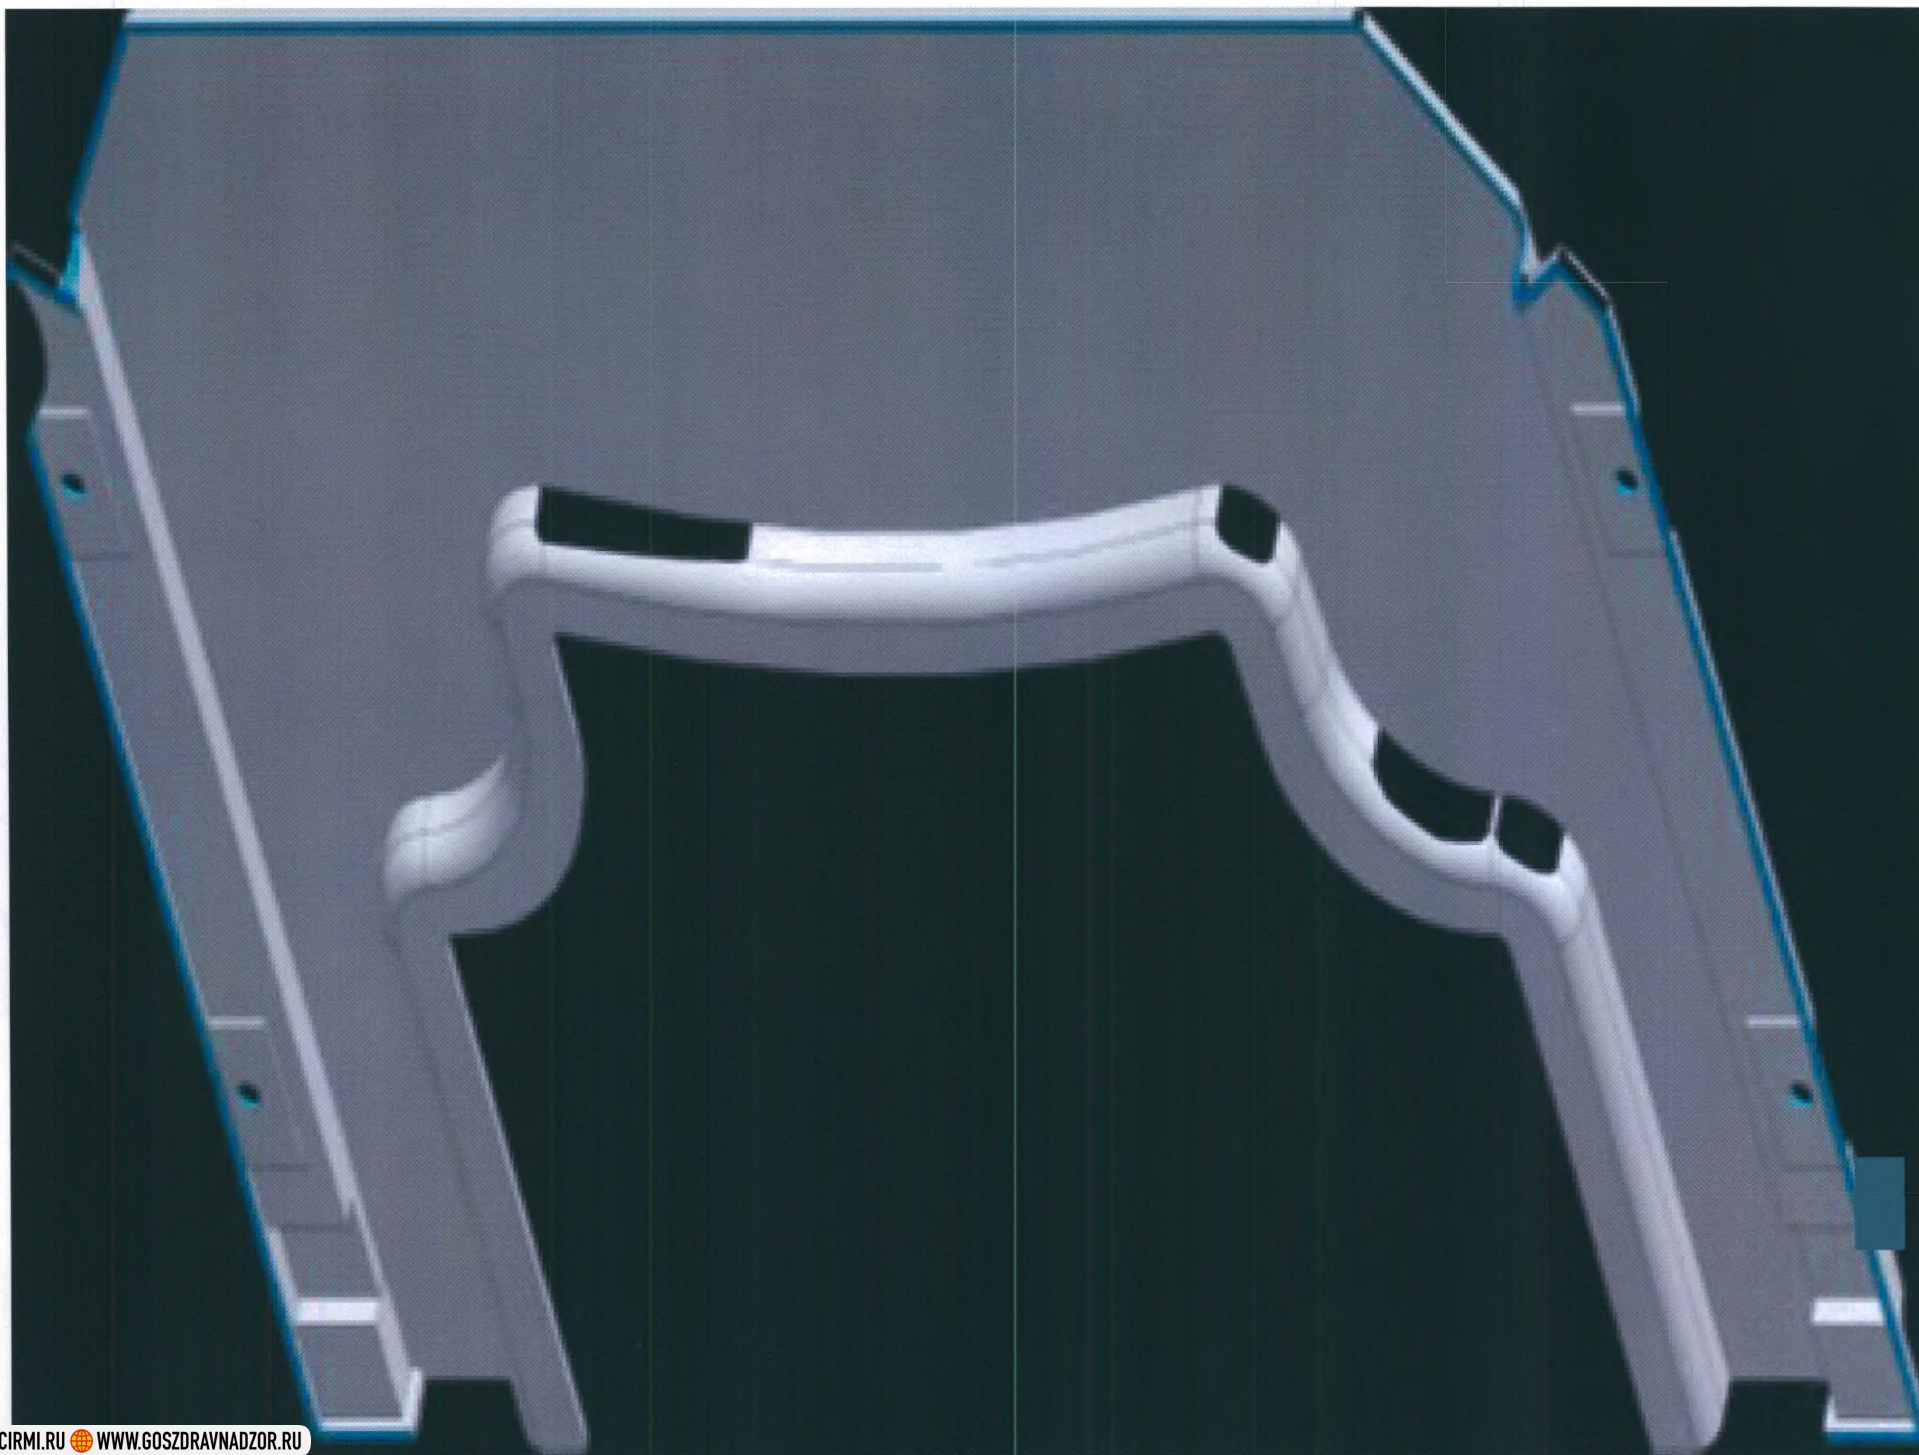


3. Стол пациента





3. Стол пациента

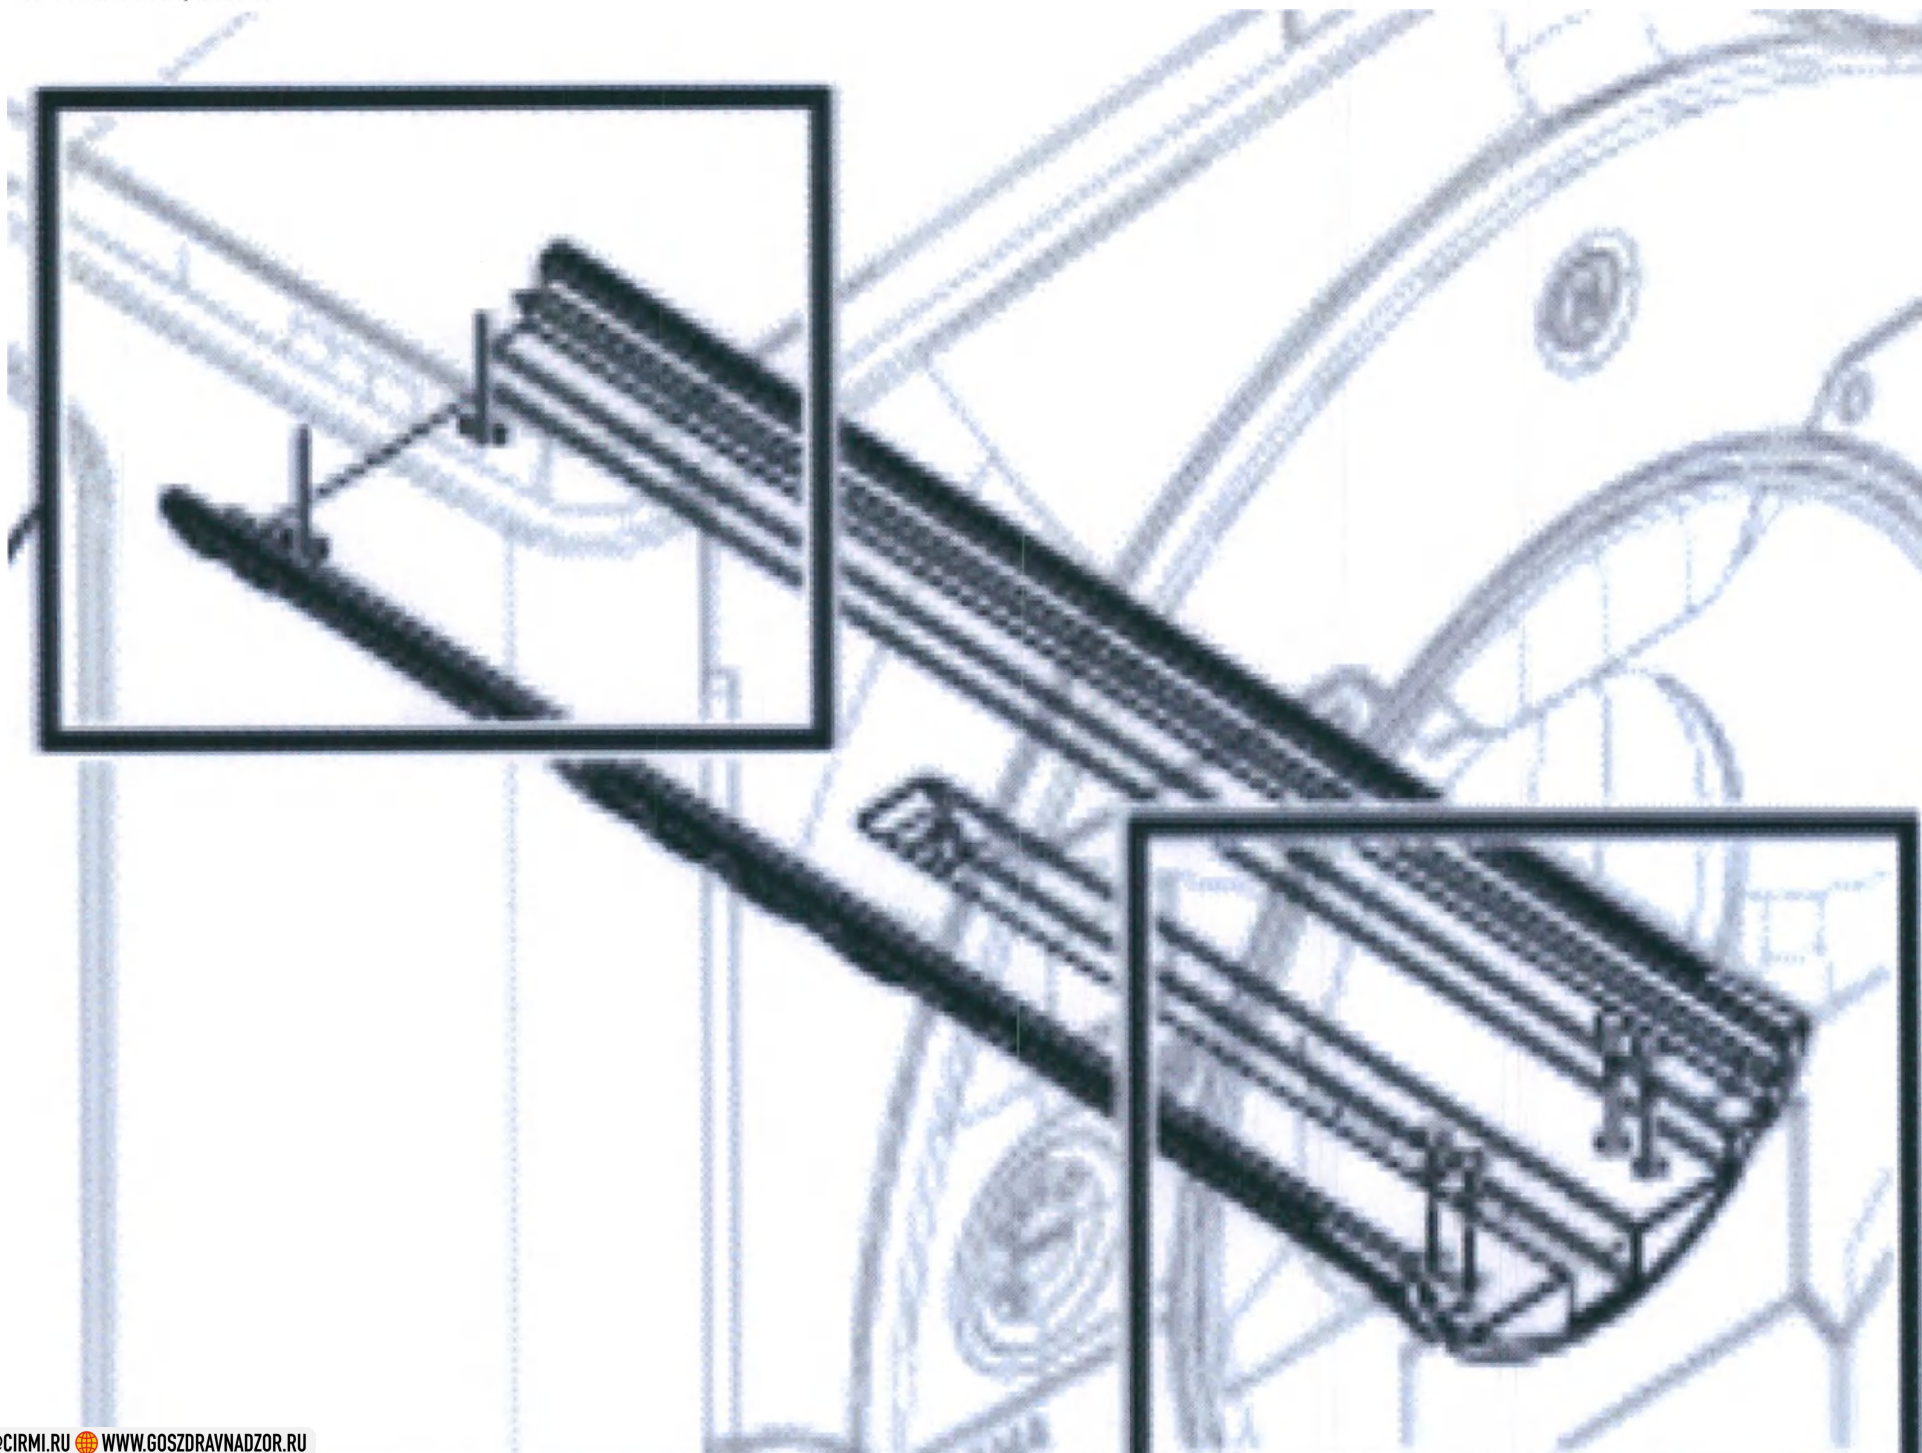

3. Стол пациента

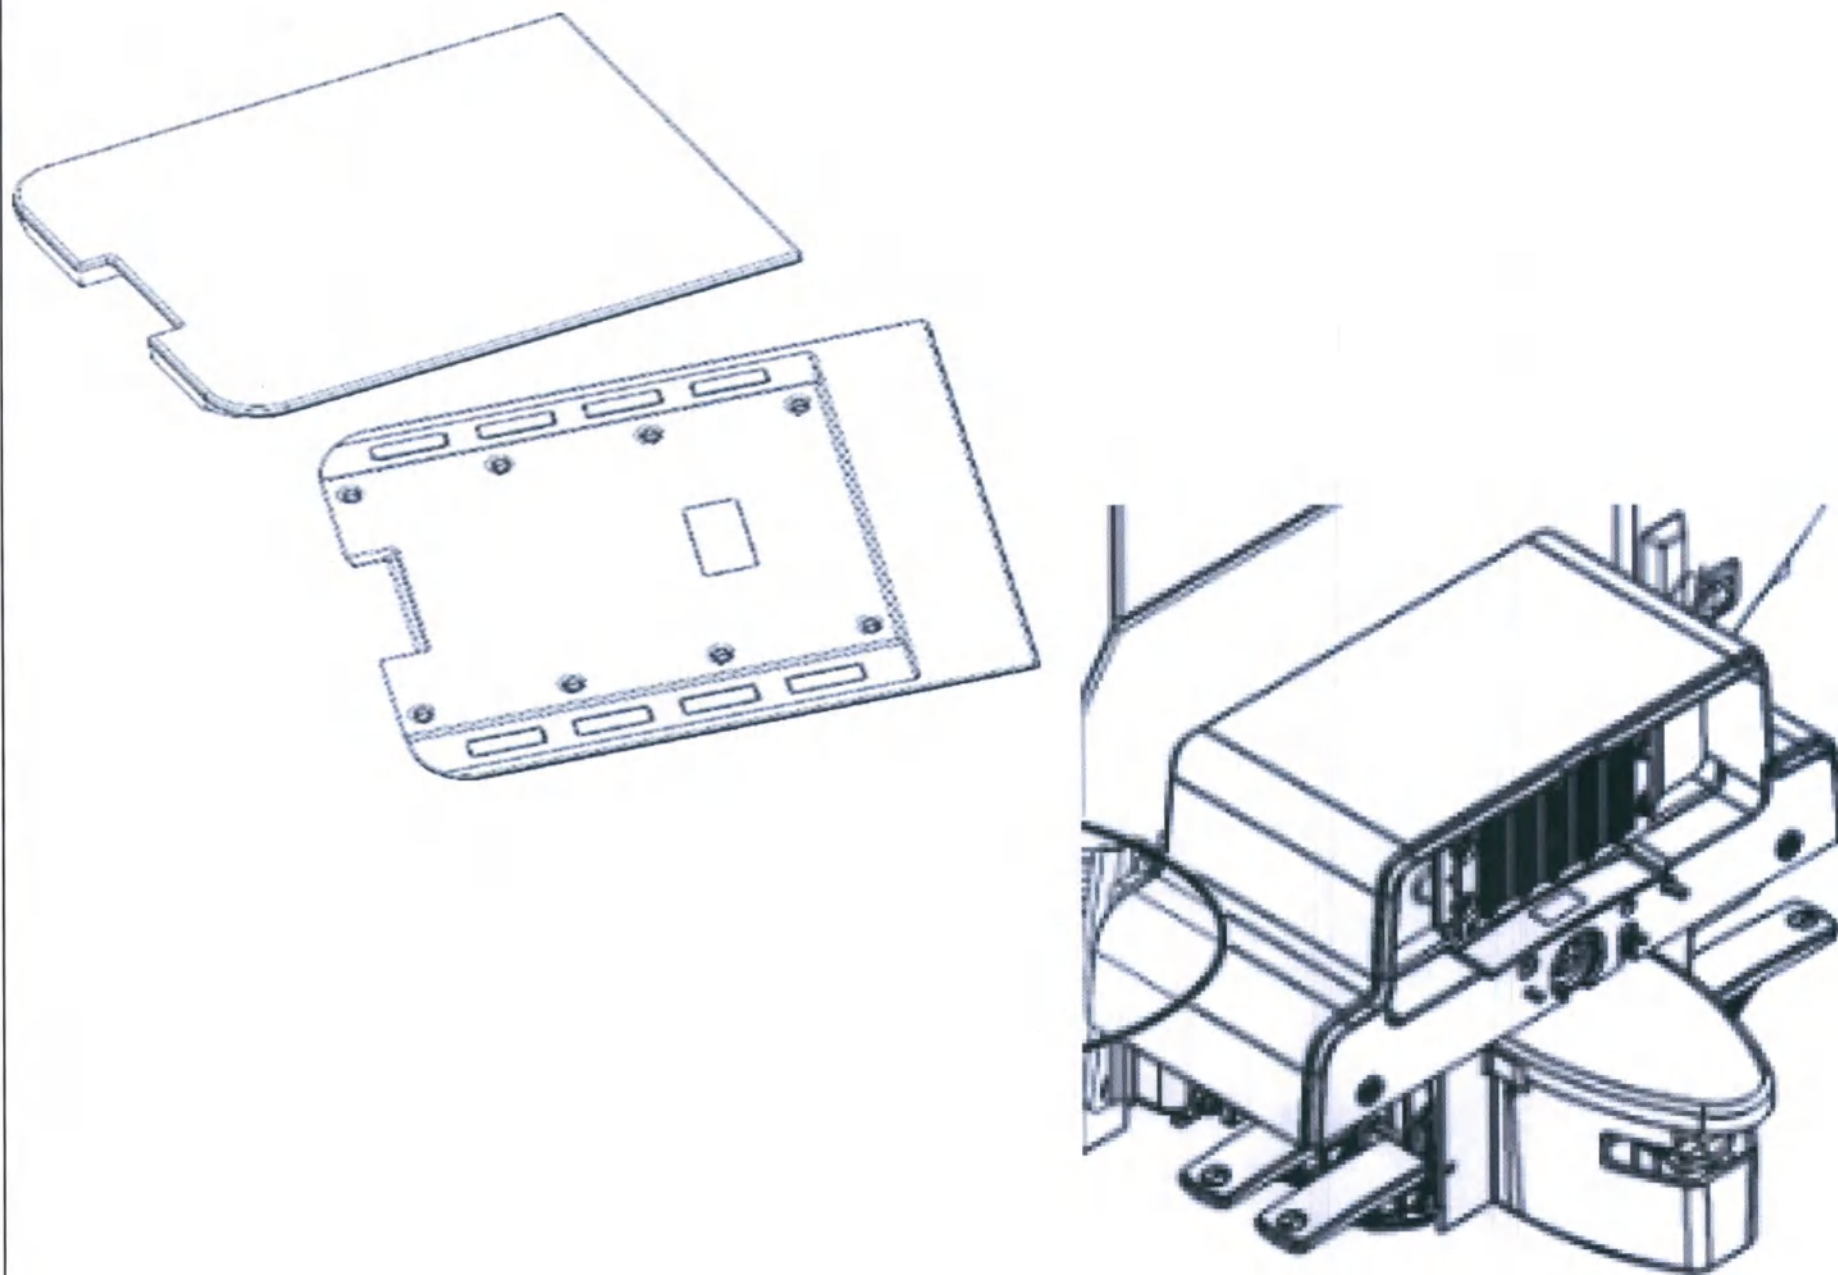

3. Стол пациента

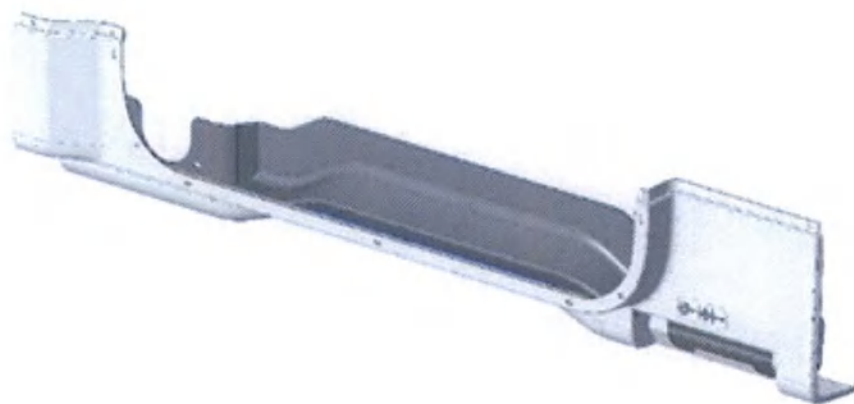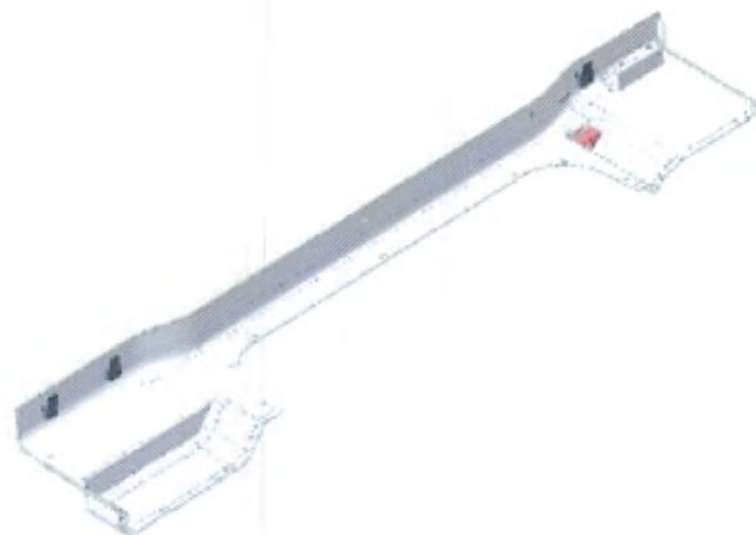

4. Эксплуатационная документация



4. Эксплуатационная документация

SIGNA™ Premier

Руководство оператора SIGNA™ Works



SIGNA™ Premier
29.1 Руководство оператора, русский язык
5860865-1RU (2021-07) Ред. 2
© 2021 General Electric Company
Все права защищены.


Конфиденциальность и безопасность для систем МРТ

Руководство оператора




Конфиденциальность и безопасность для систем МРТ
Руководство оператора, версия 29.1, русский язык
5860821-1RU (12.2020) Ред. 1
© General Electric Company, 2020
Все права сохранены.

5. Шкафы управления системой

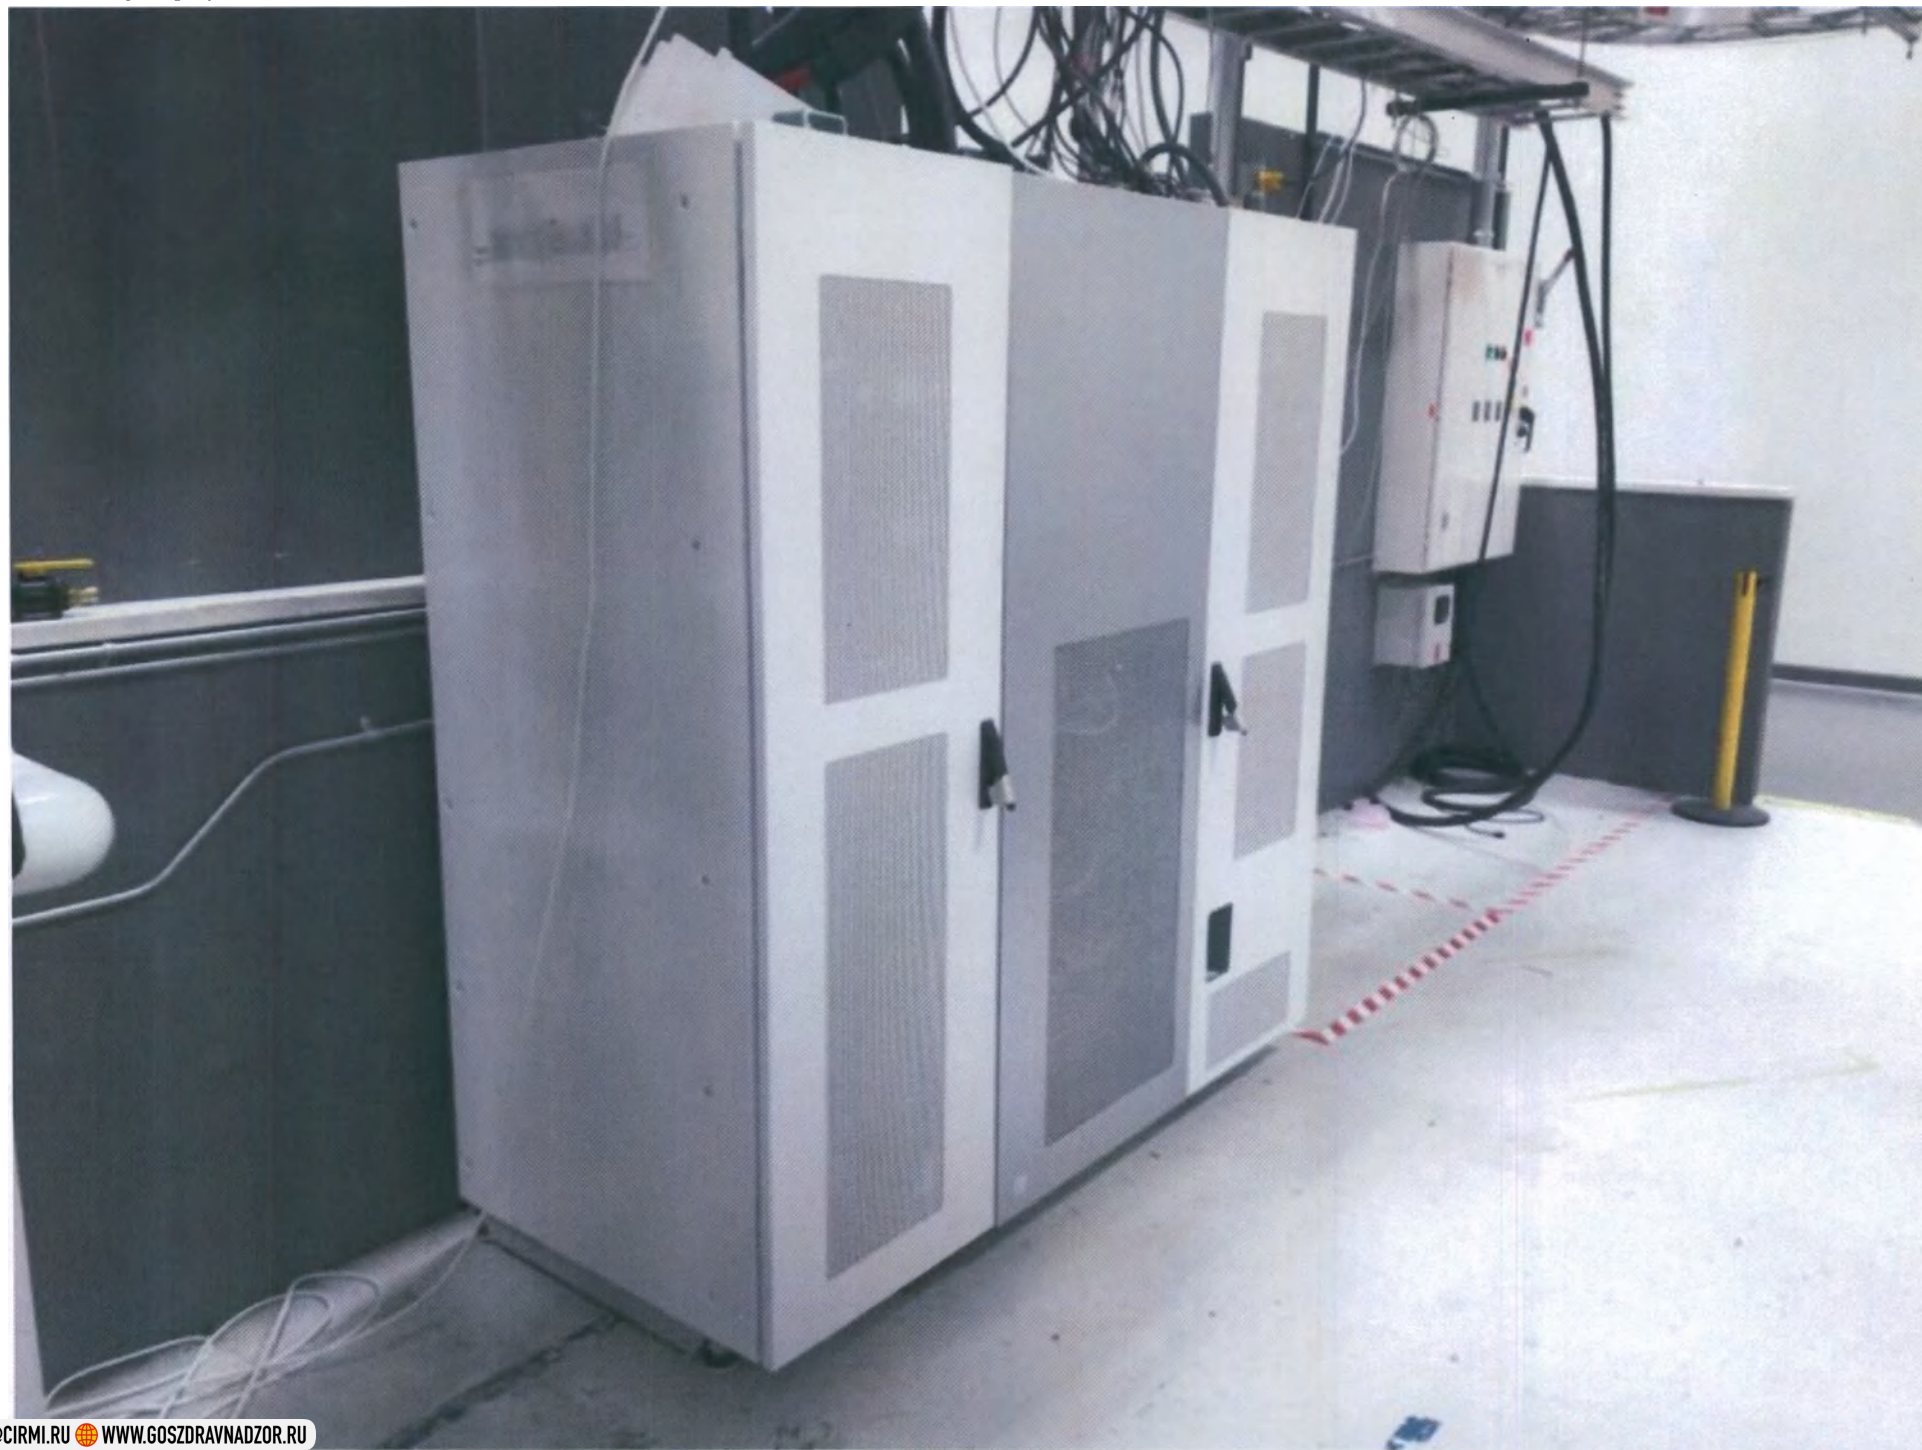


5. Шкафы управления системой

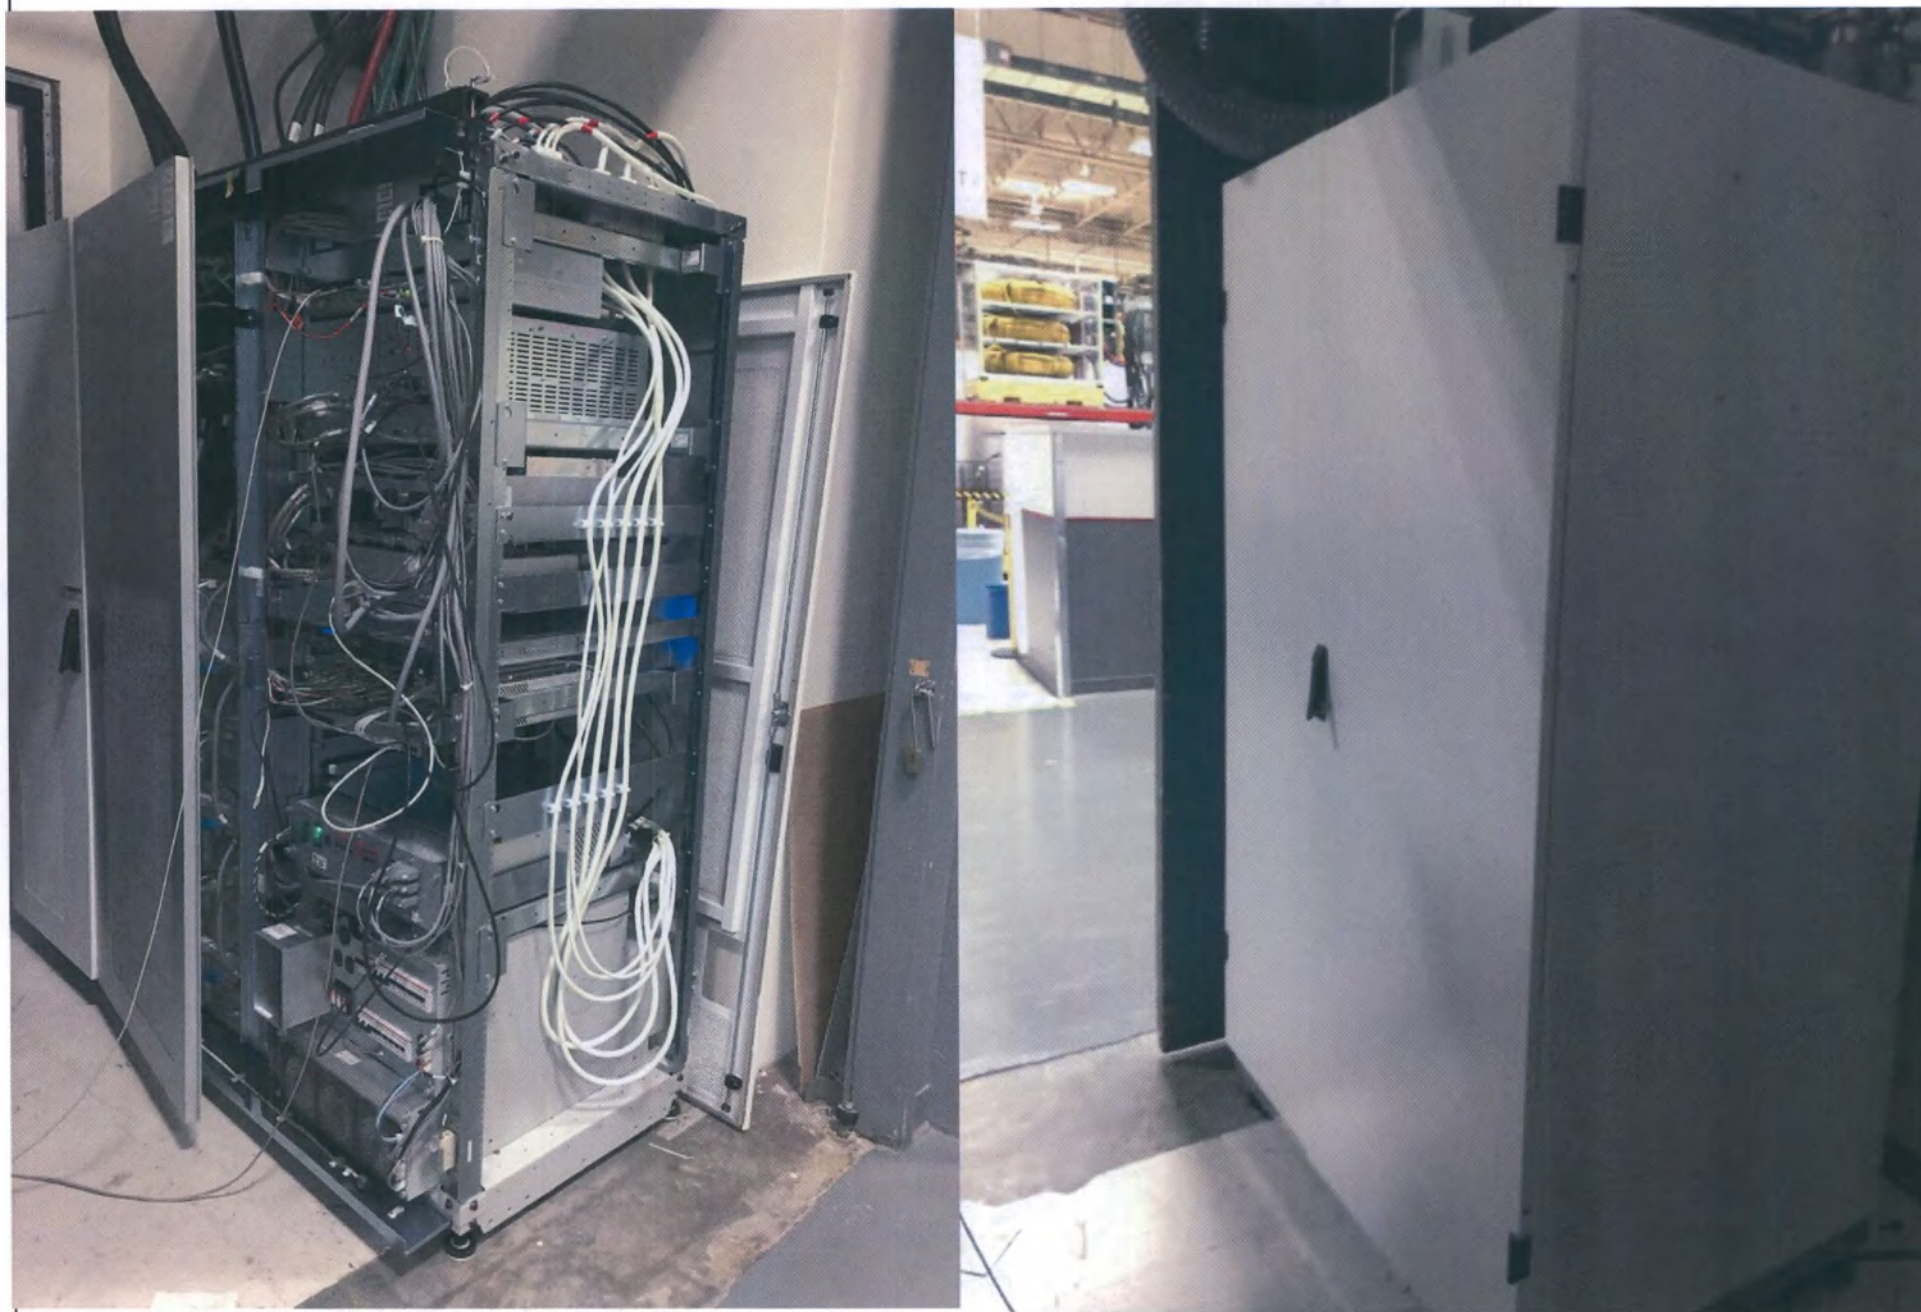

Принадлежности: 1. Блоки охлаждения МР-томографа



1. Блоки охлаждения МР-томографа

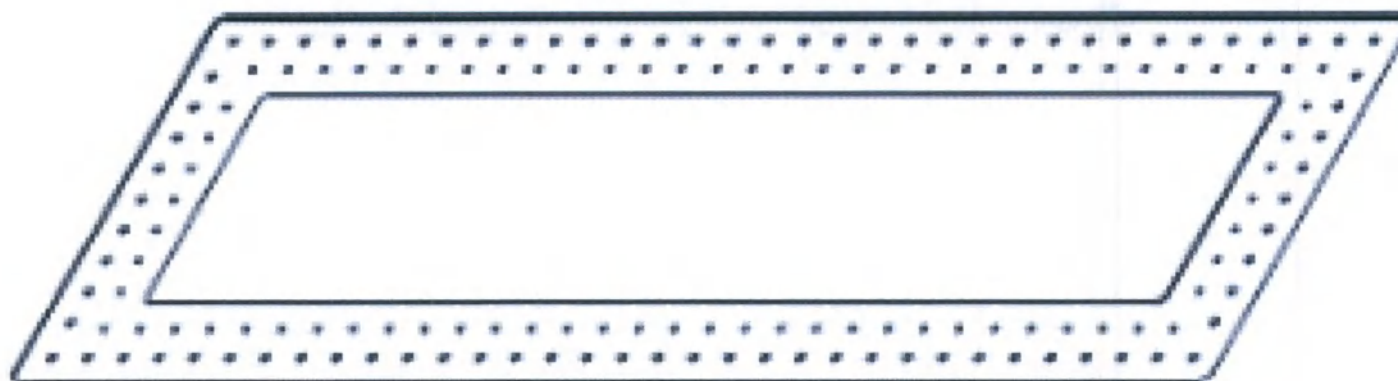


1. Блоки охлаждения МР-томографа



1. Блоки охлаждения МР-томографа




1. Блоки охлаждения МР-томографа

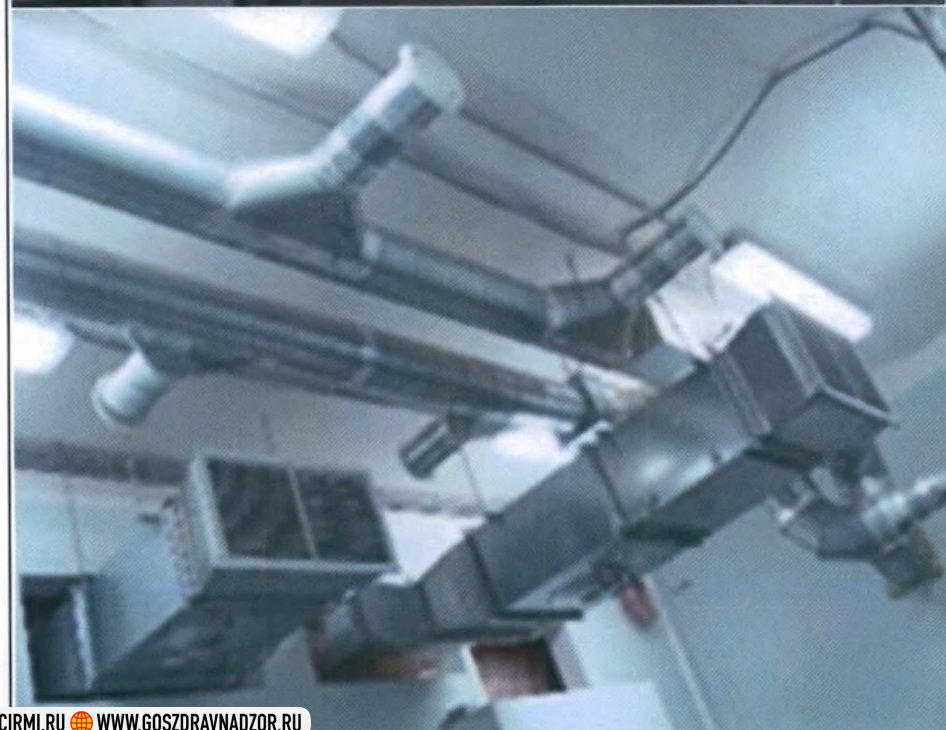

1. Блоки охлаждения МР-томографа



2. Специализированные подкладки для позиционирования и фиксации пациента

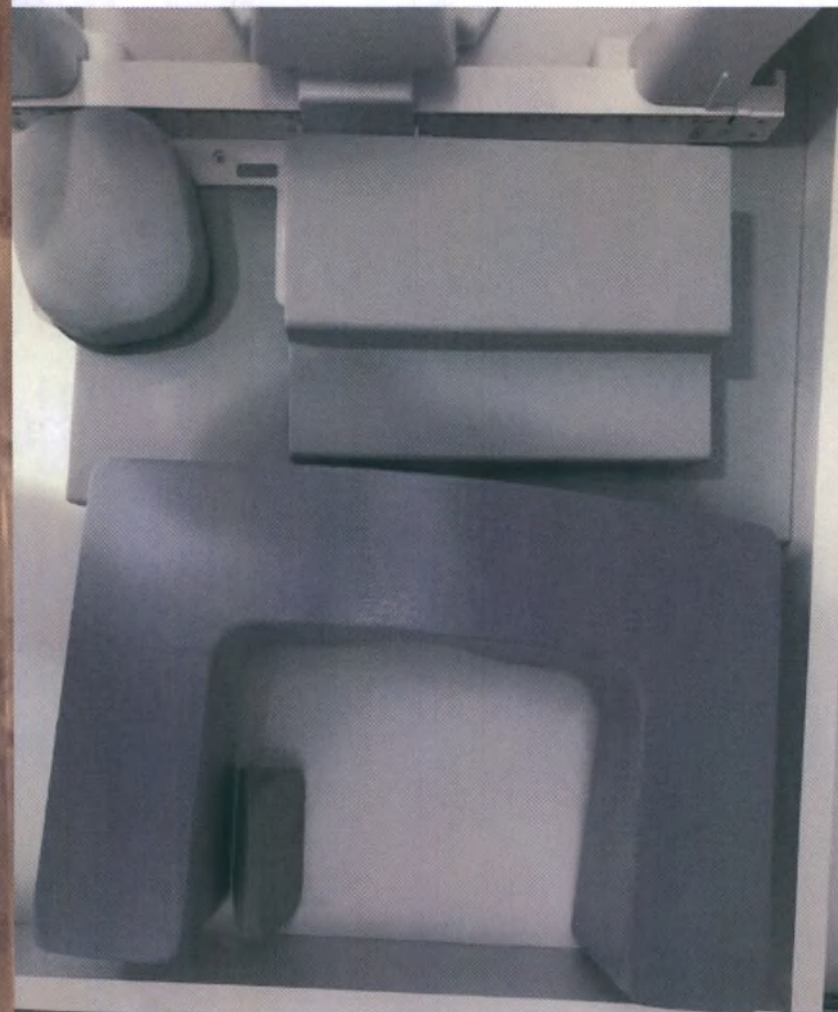


2. Специализированные подкладки для позиционирования и фиксации пациента




2. Специализированные подкладки для позиционирования и фиксации пациента



3. Виброакустические маты

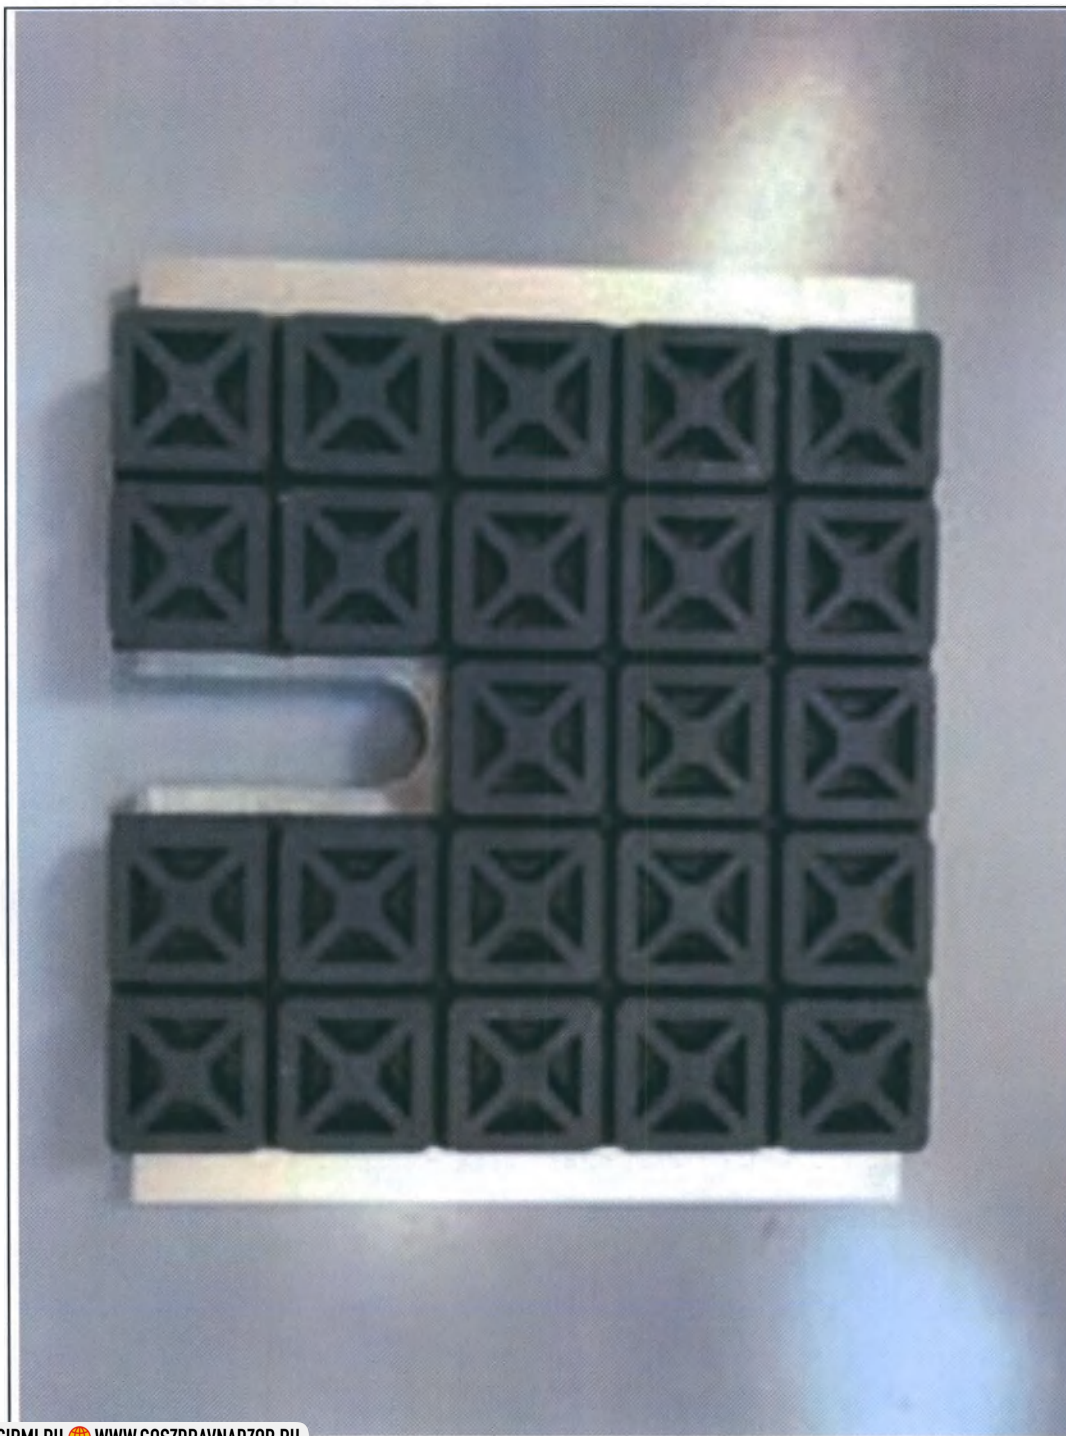

4. Непроводящие подложки для защиты пациента

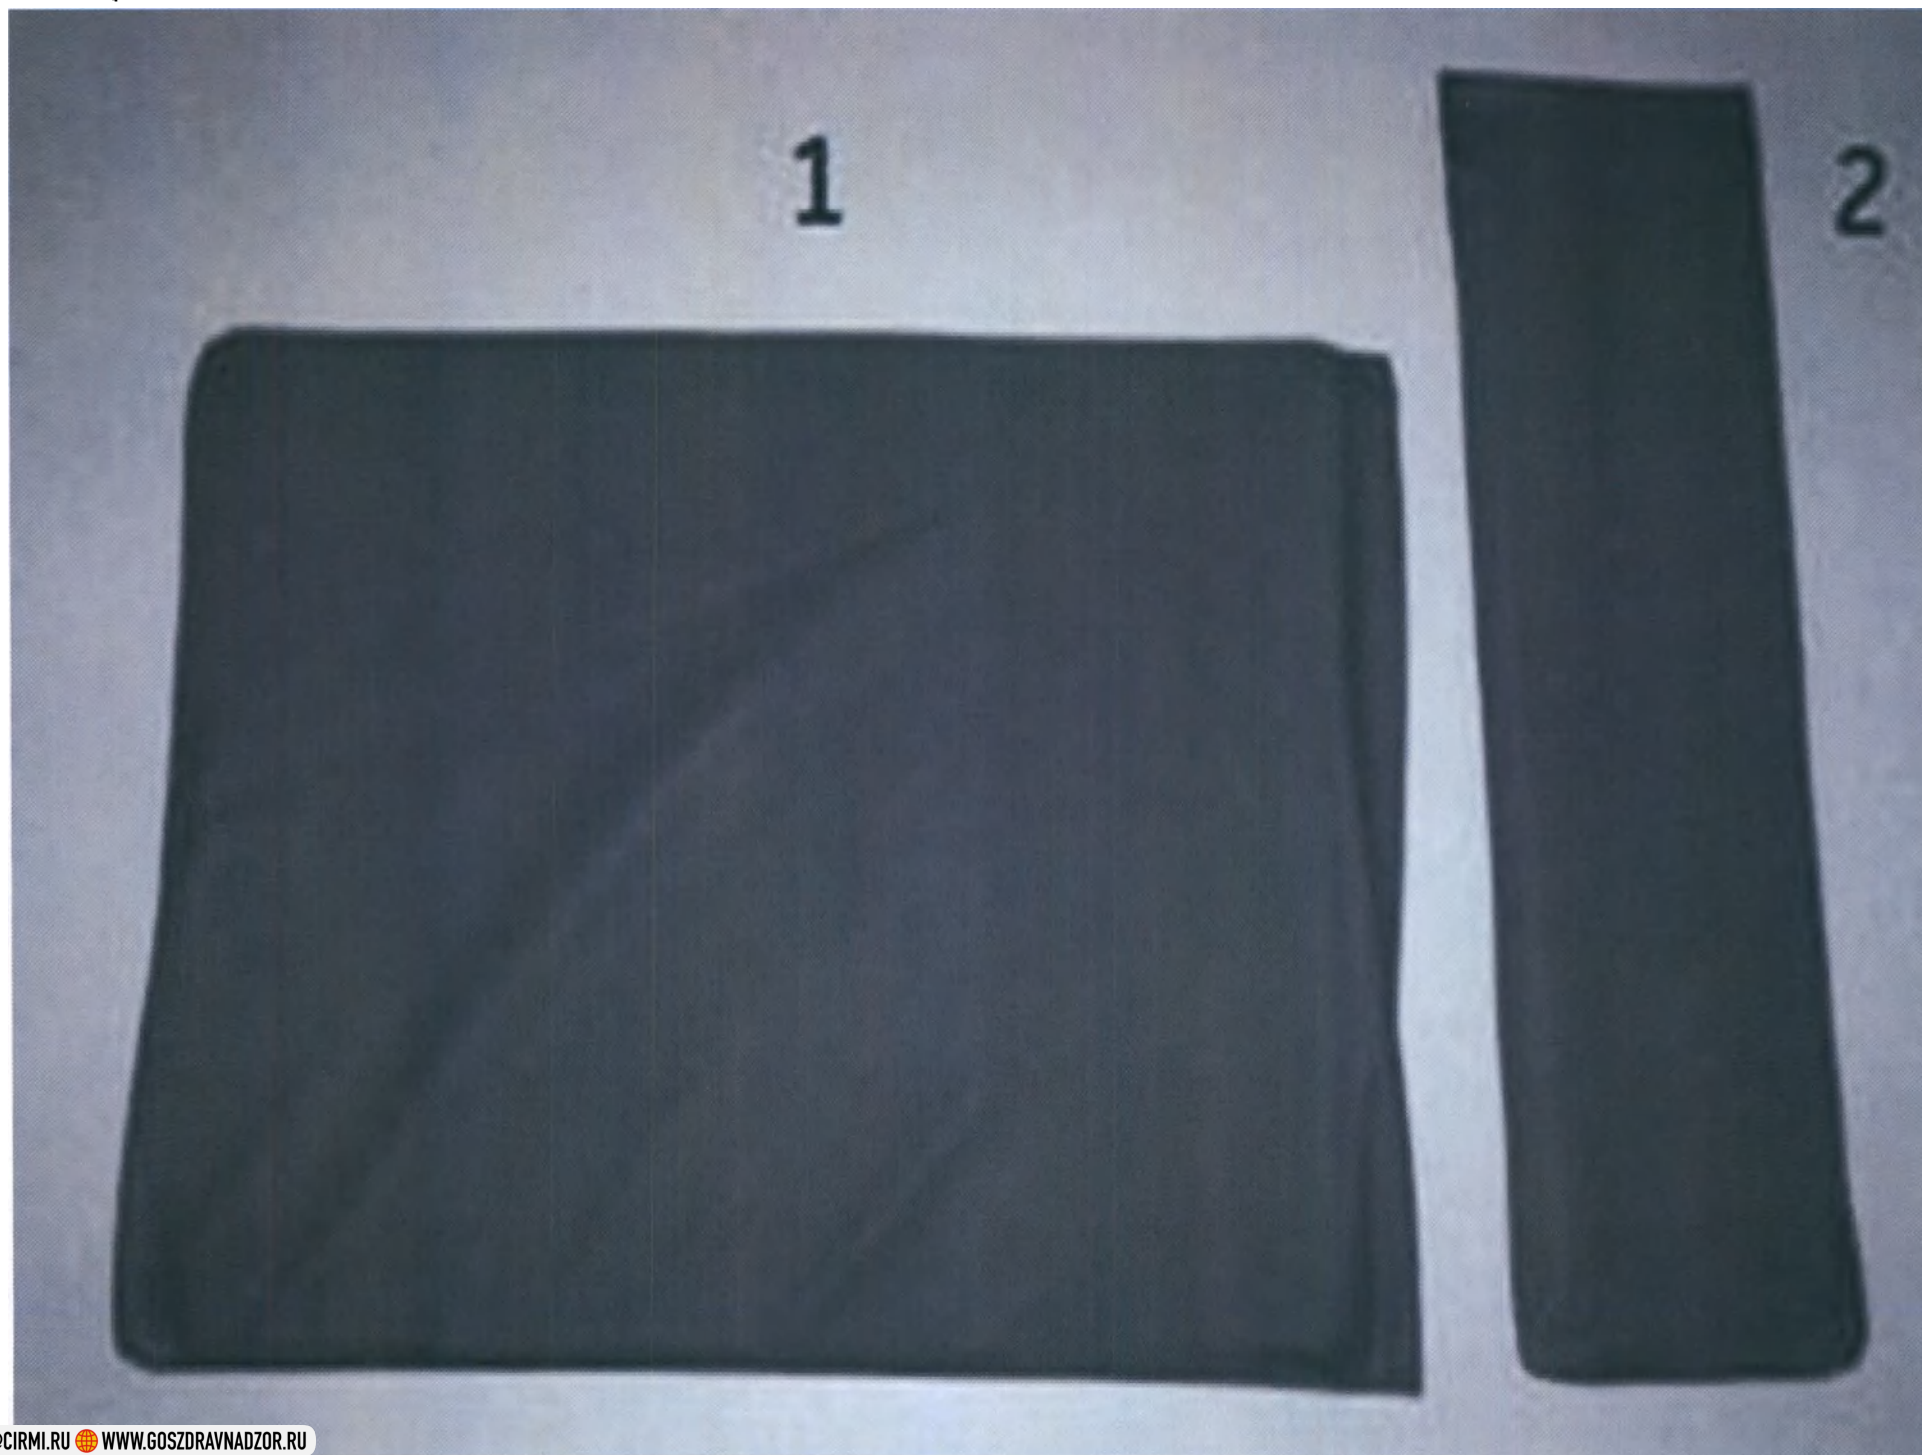


5. Источники бесперебойного питания



5. Источники бесперебойного питания



5. Источники бесперебойного питания

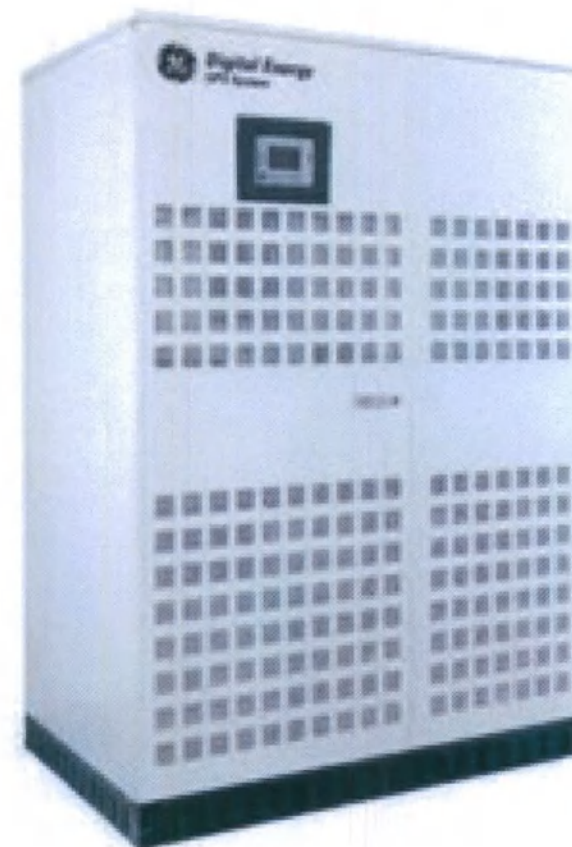


5. Источники бесперебойного питания



5. Источники бесперебойного питания



6. Кабели

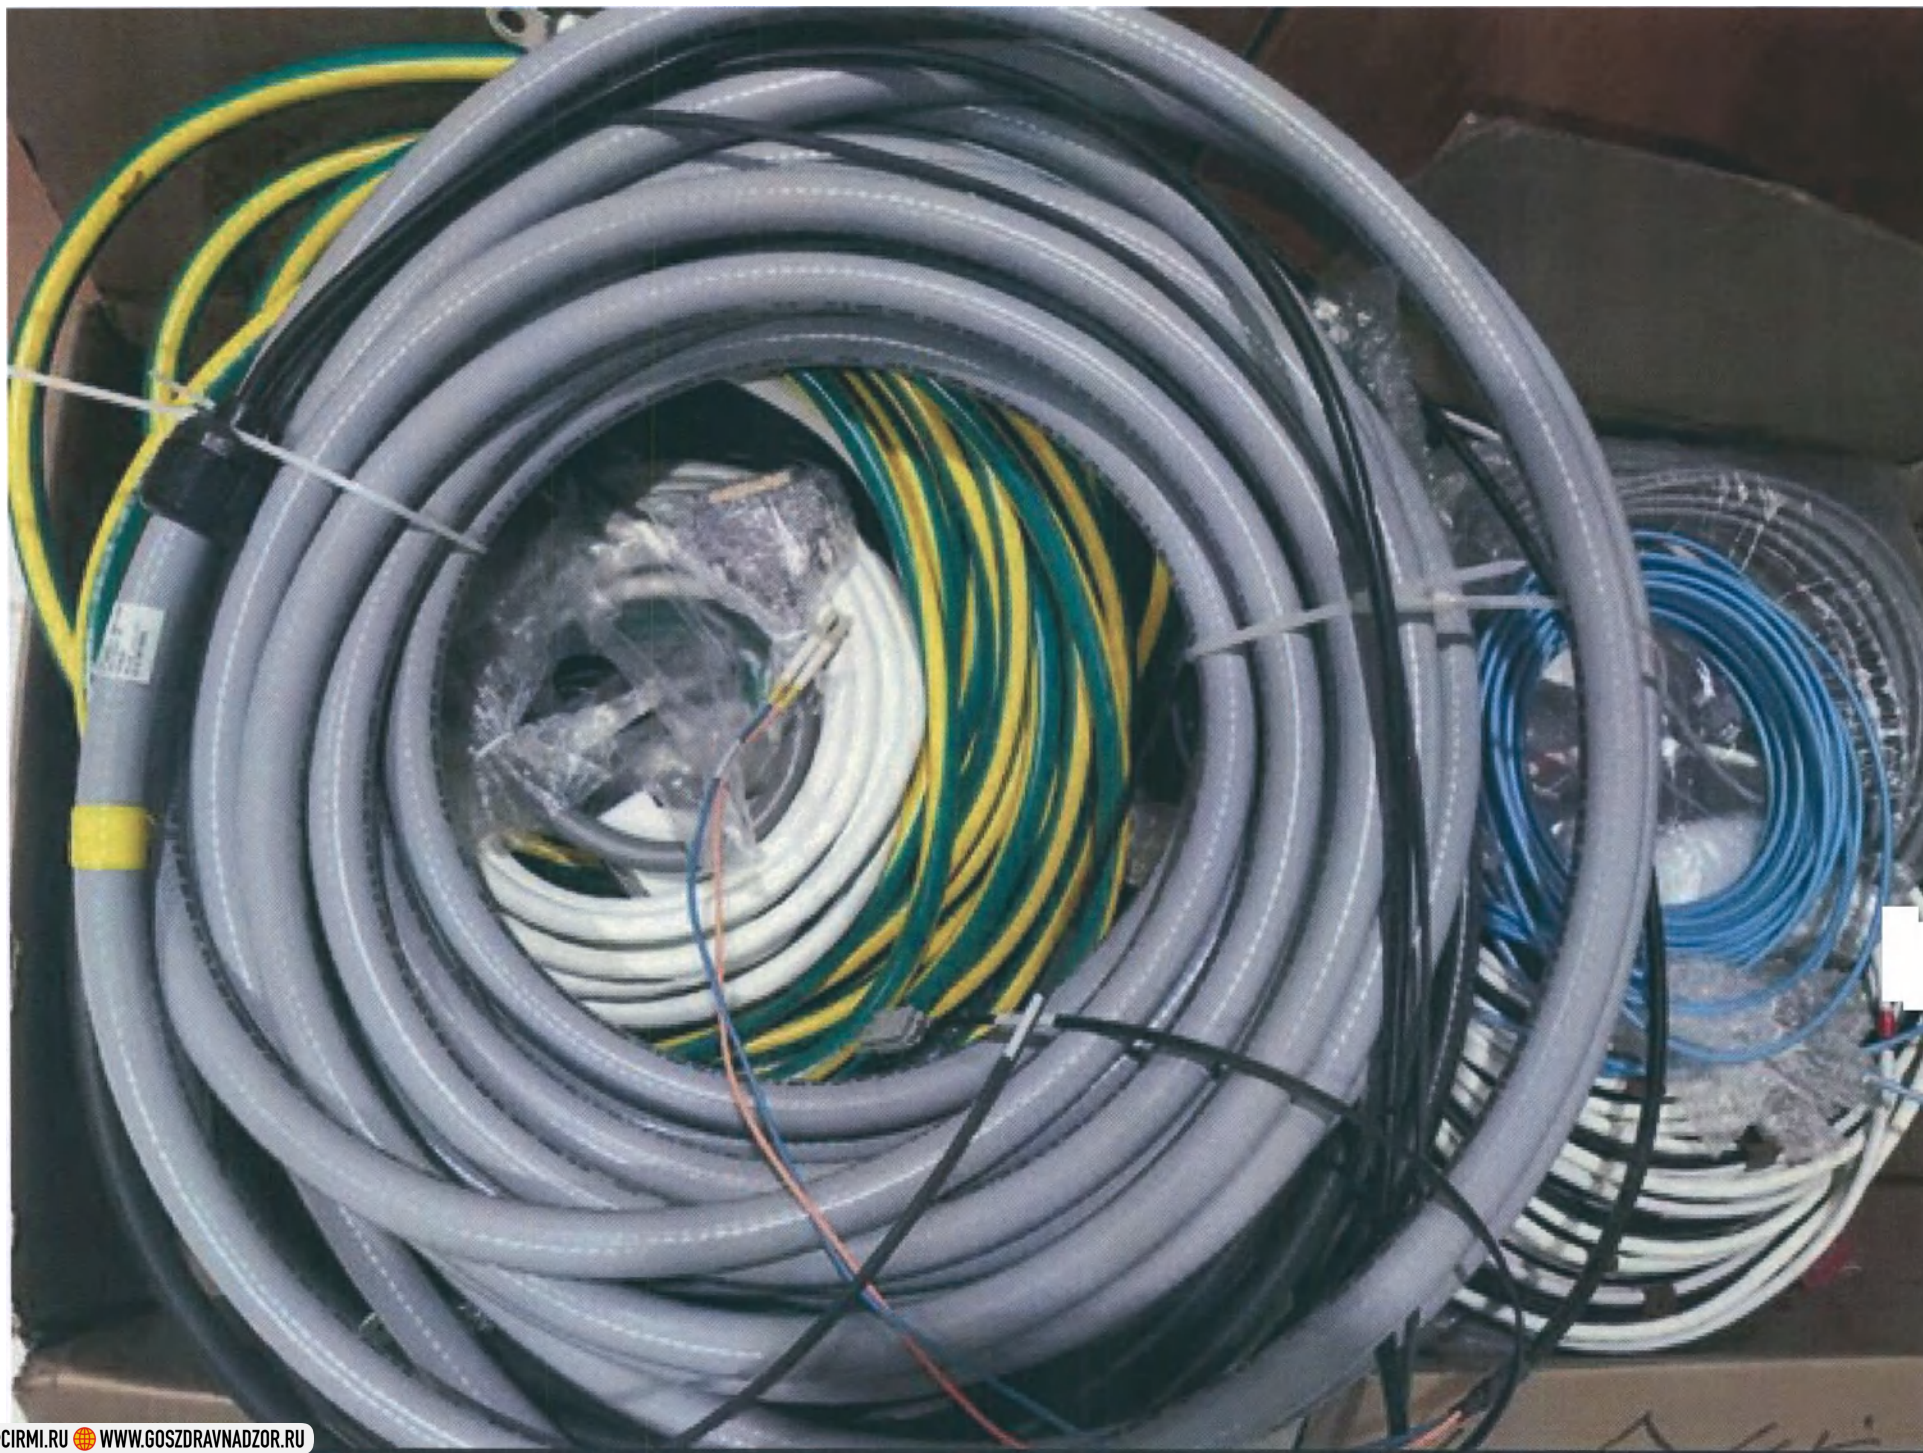



6. Кабели



6. Кабели




7. Катушка для исследования позвоночника

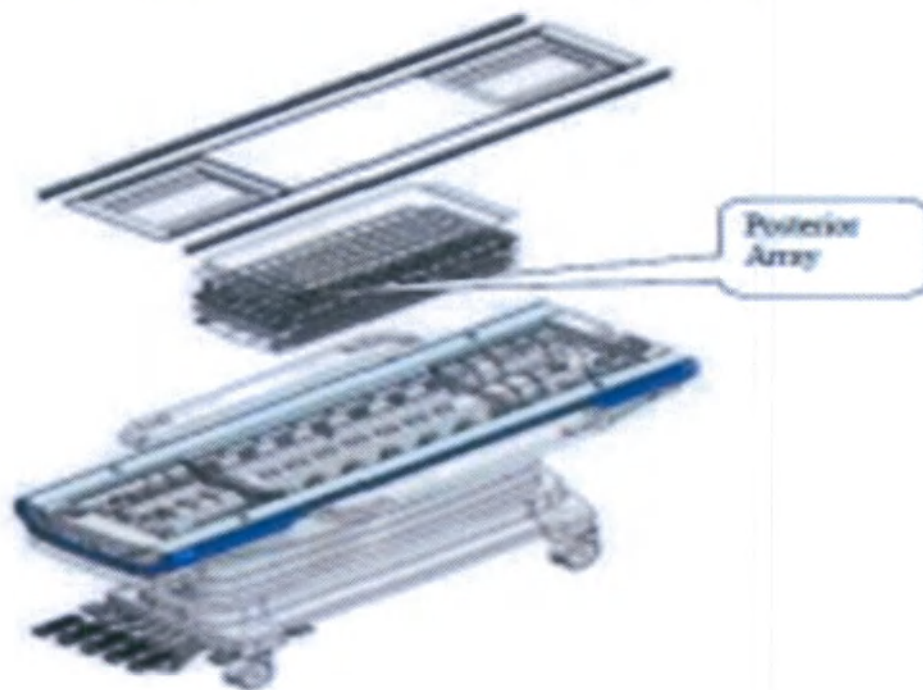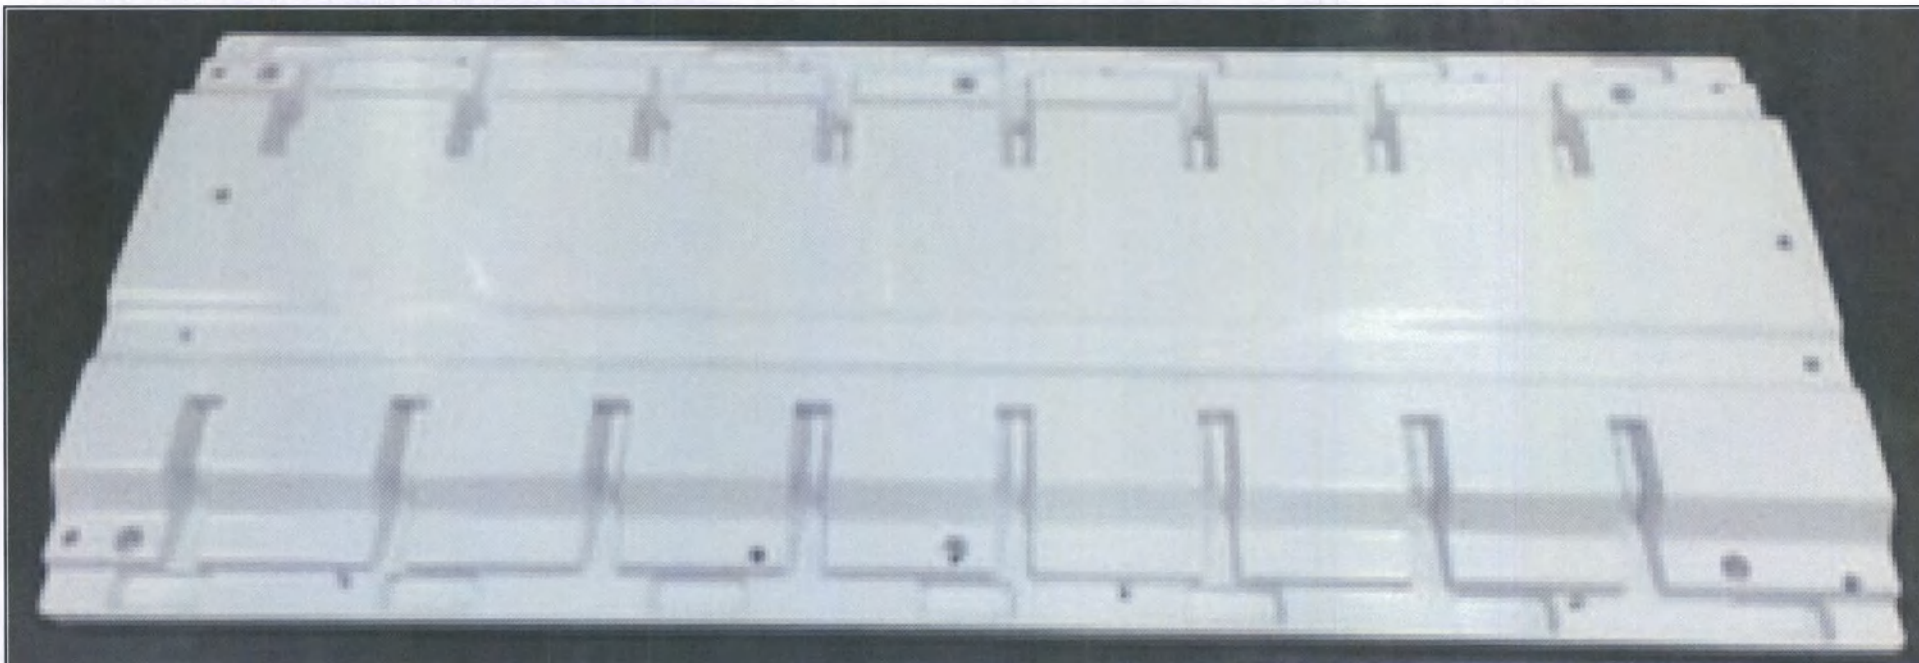


8. Катушки гибкие для исследований



8. Катушки гибкие для исследований

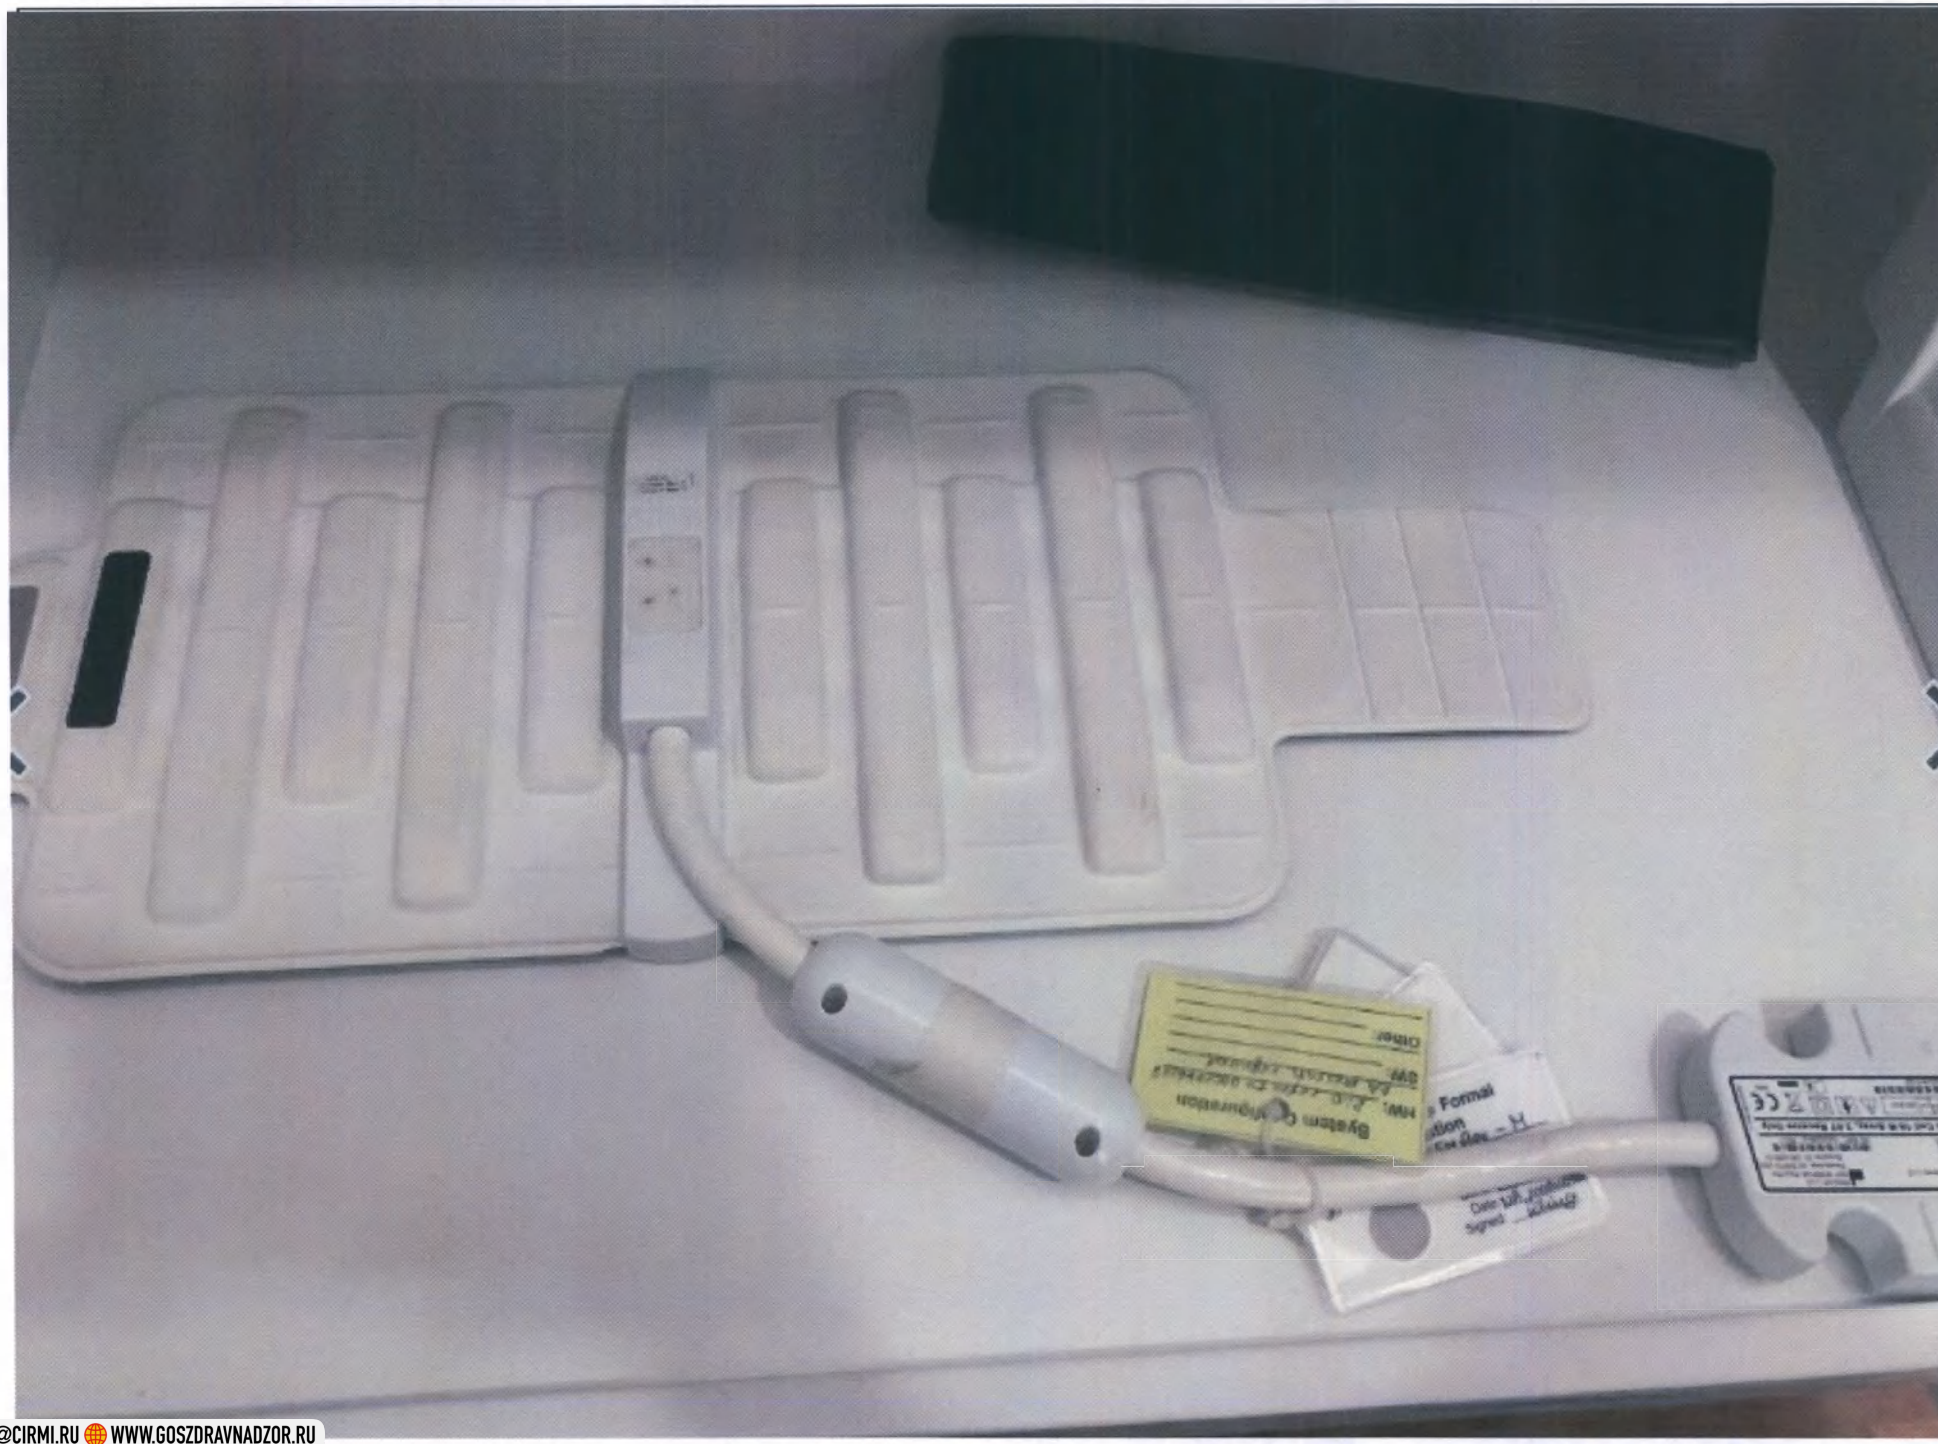

8. Катушки гибкие для исследований

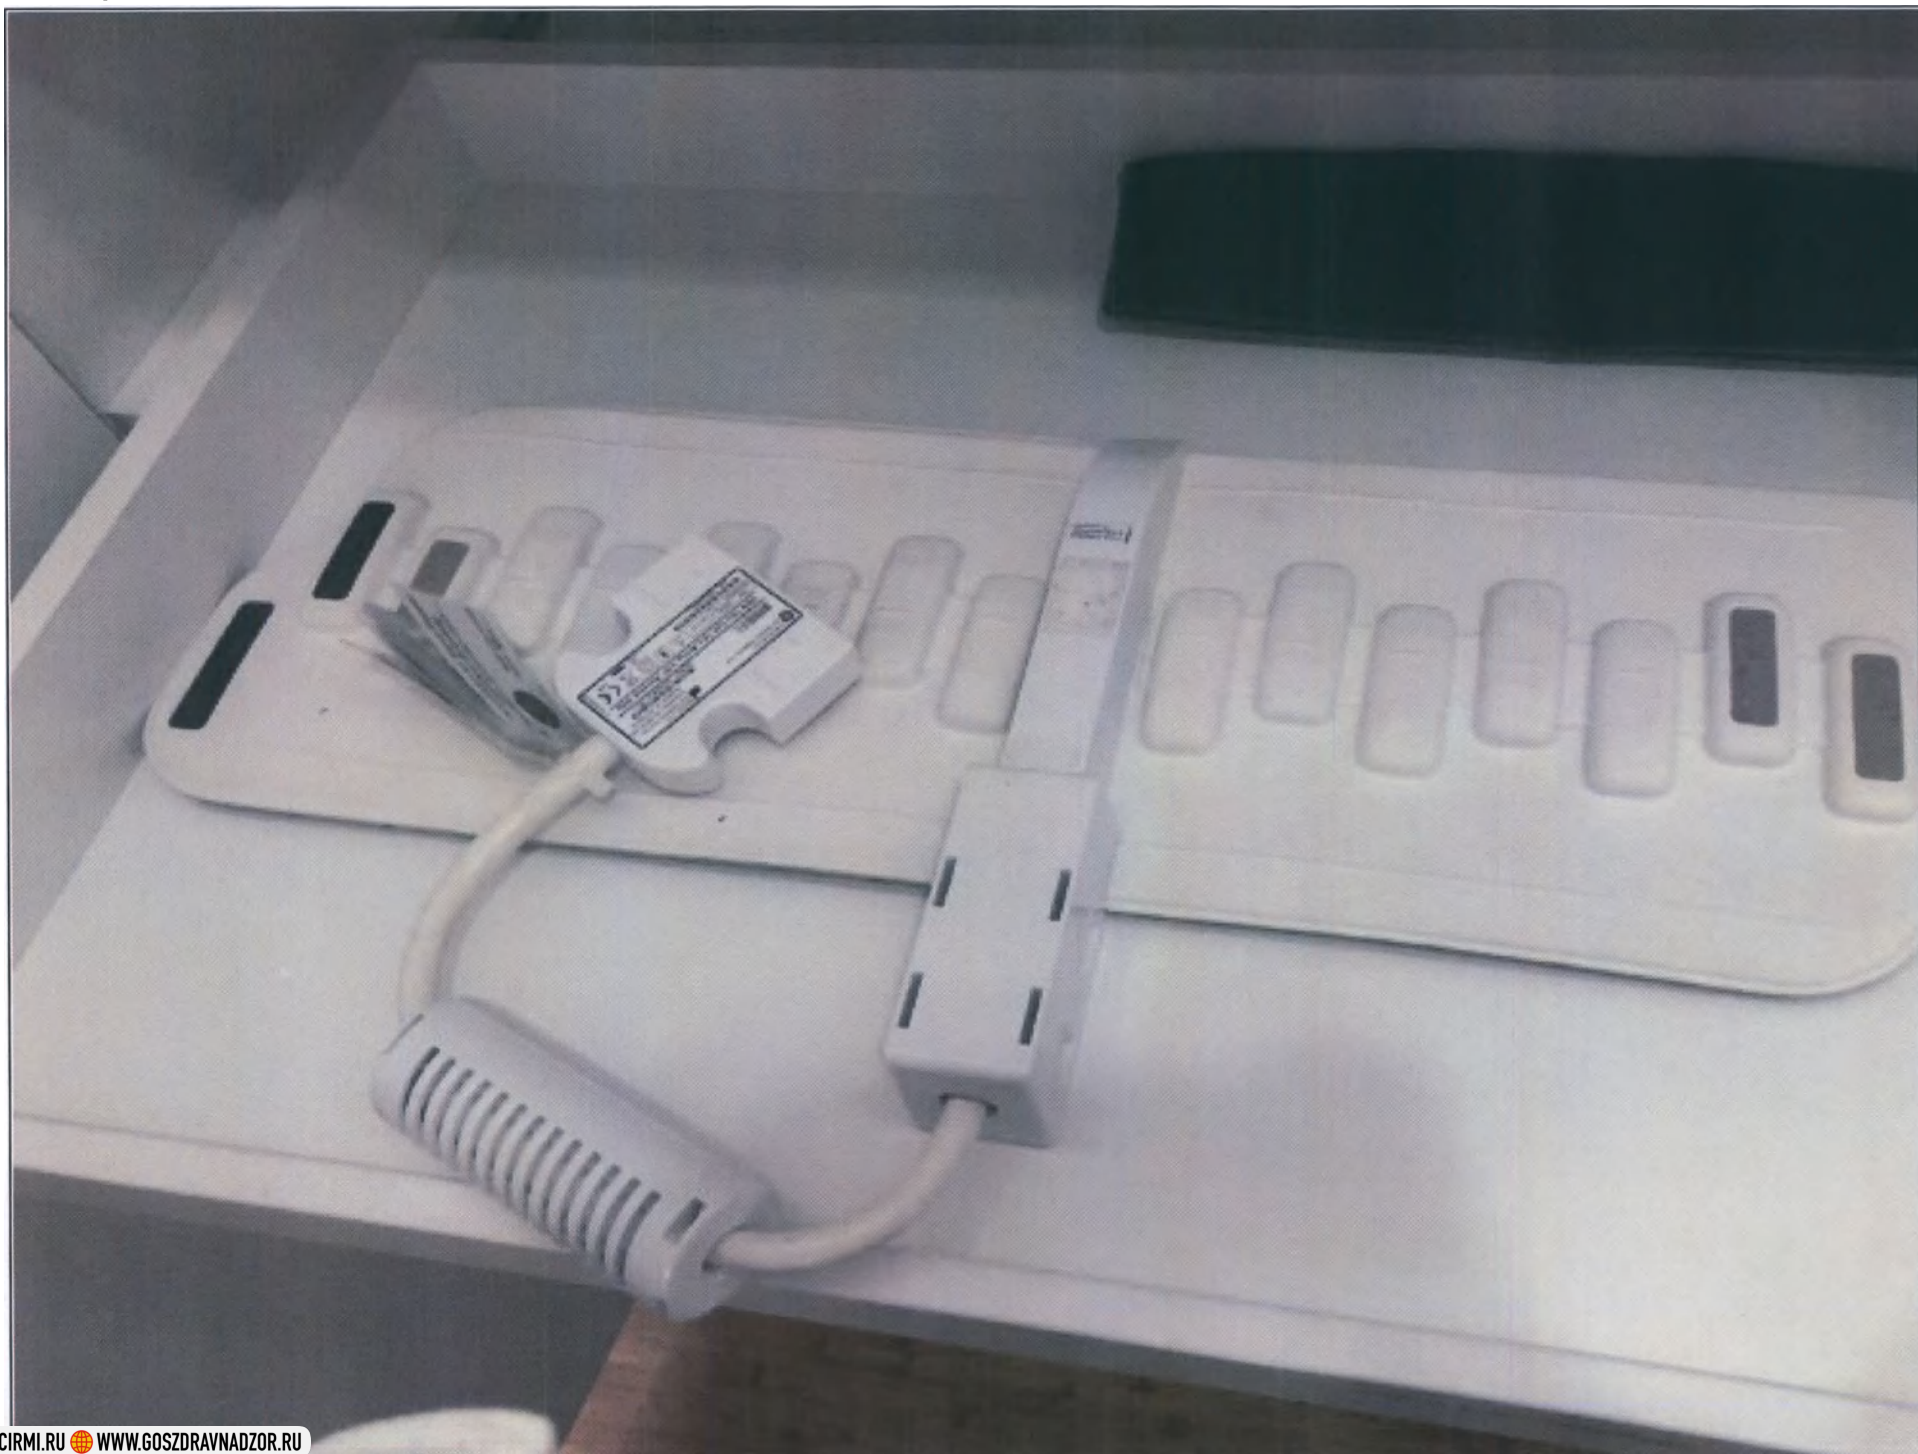

9. Катушки для исследования верхних конечностей



9. Катушки для исследования верхних конечностей



9. Катушки для исследования верхних конечностей



9. Катушки для исследования верхних конечностей



10. Катушки для исследования головы и шеи




10. Катушки для исследования головы и шеи



10. Катушки для исследования головы и шеи




10. Катушки для исследования головы и шеи

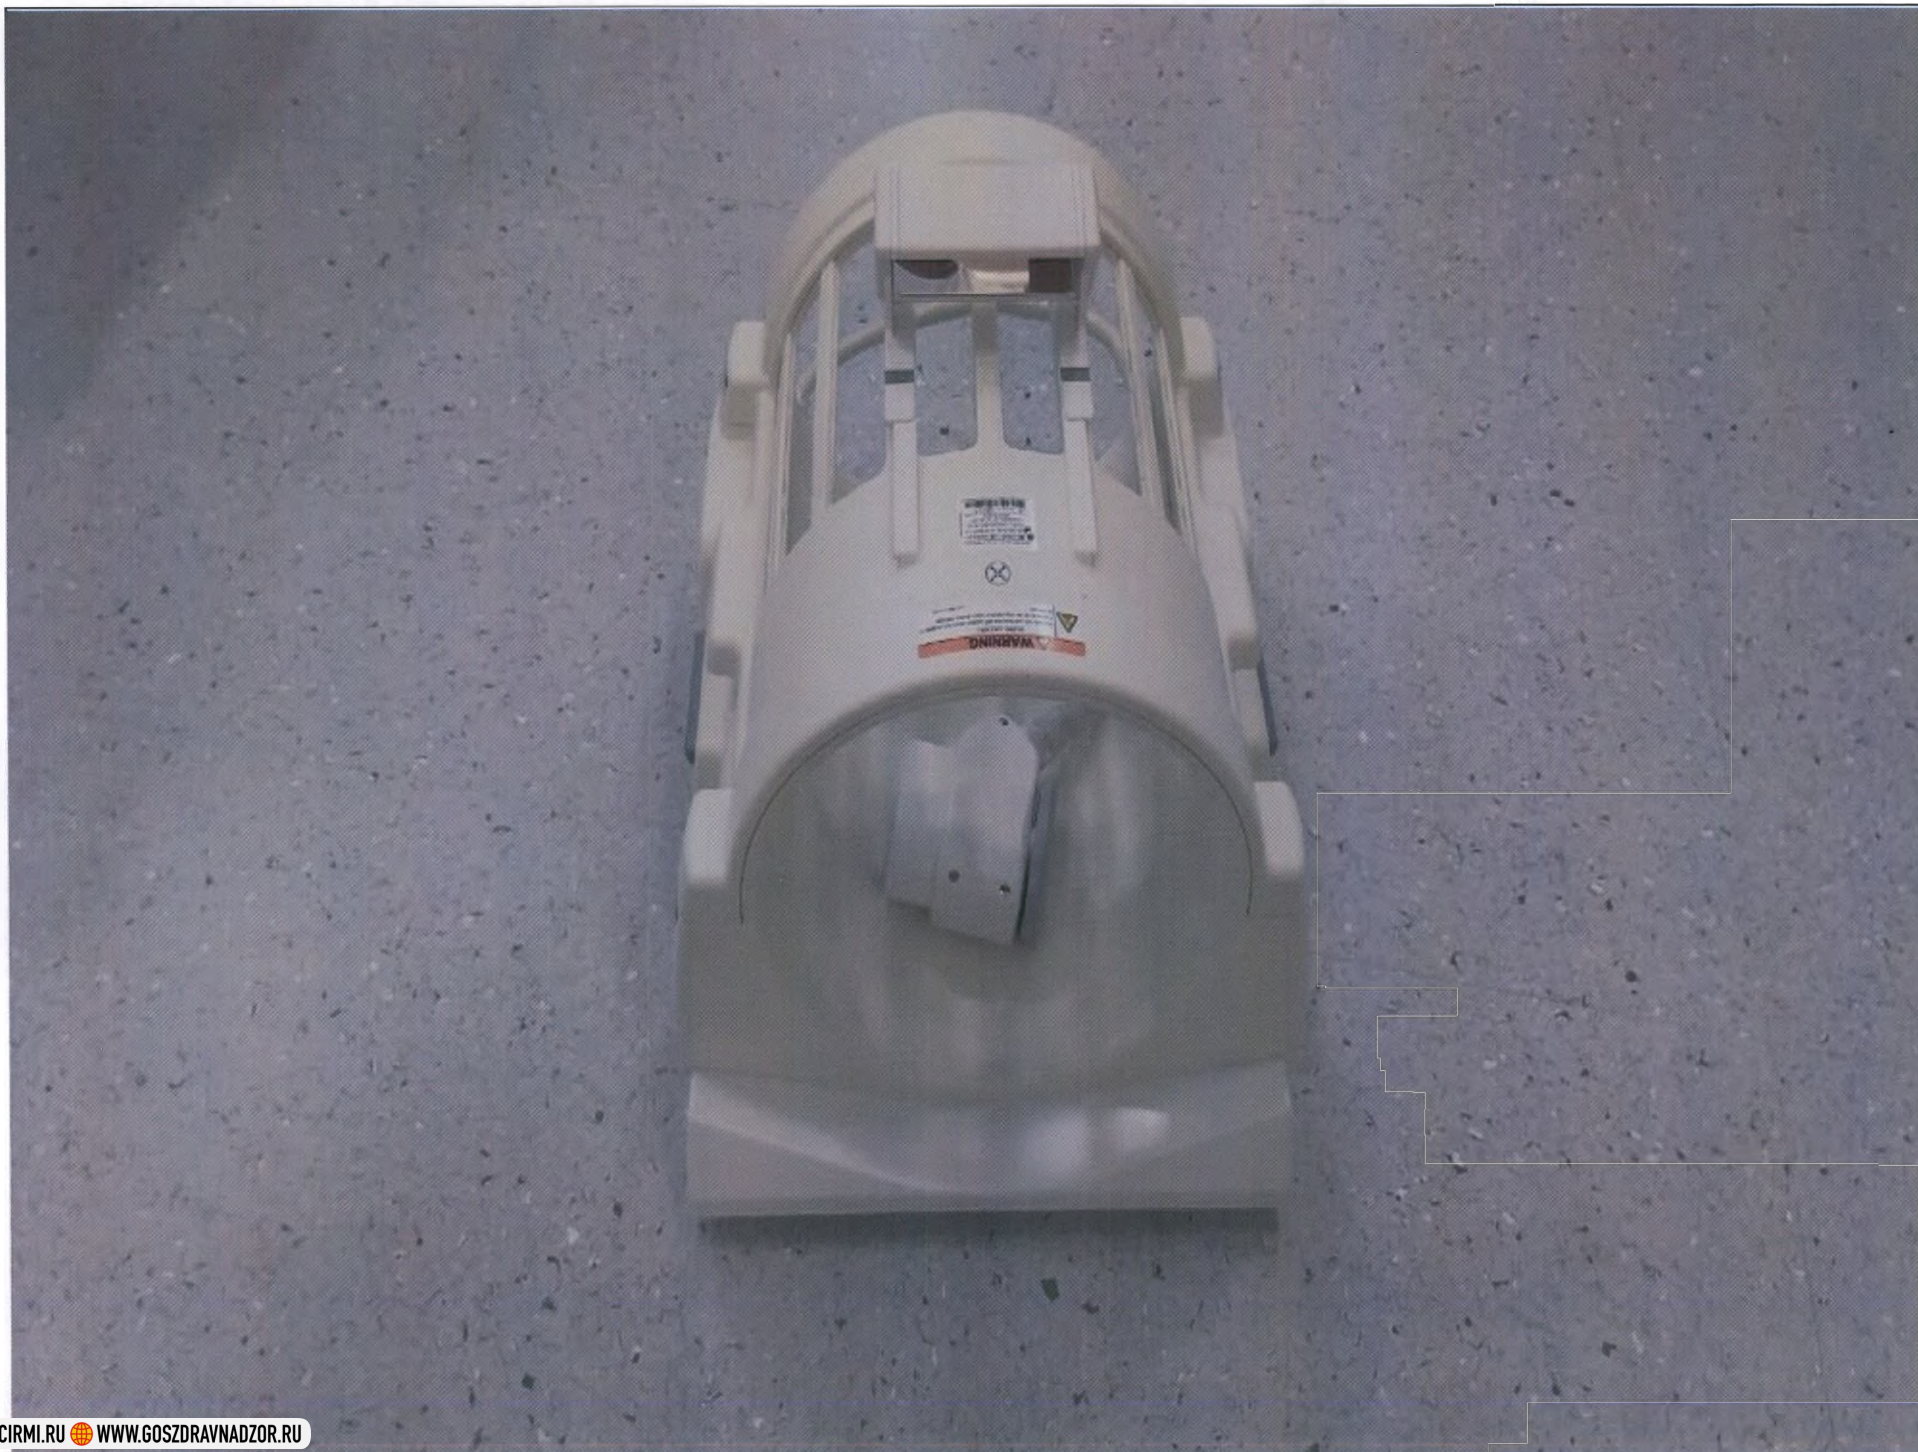

10. Катушки для исследования головы и шеи




10. Катушки для исследования головы и шеи

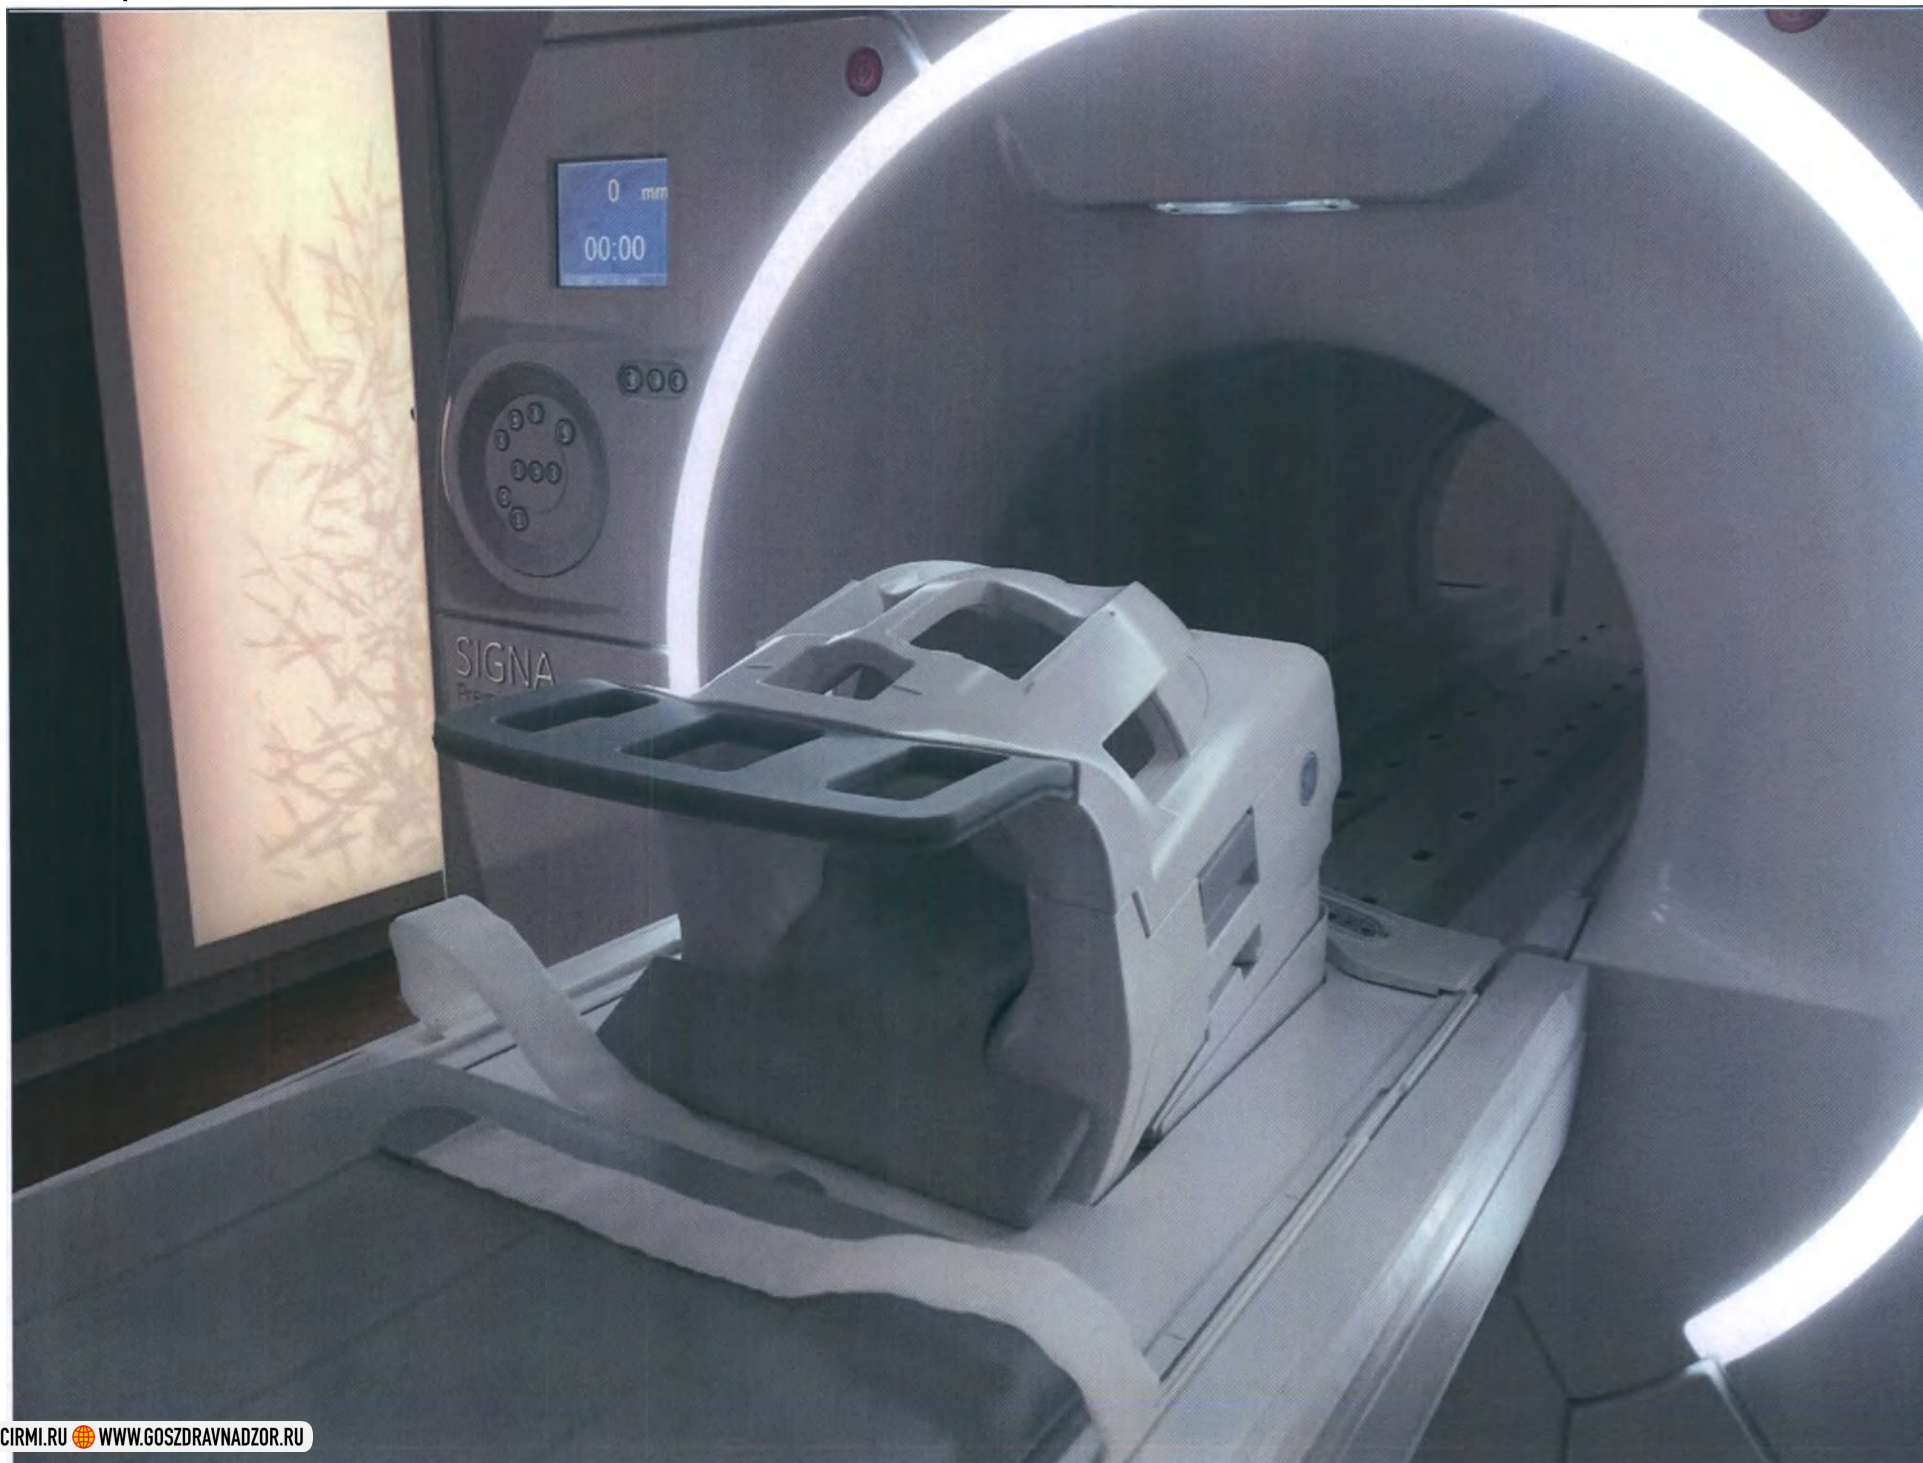

10. Катушки для исследования головы и шеи




10. Катушки для исследования головы и шеи

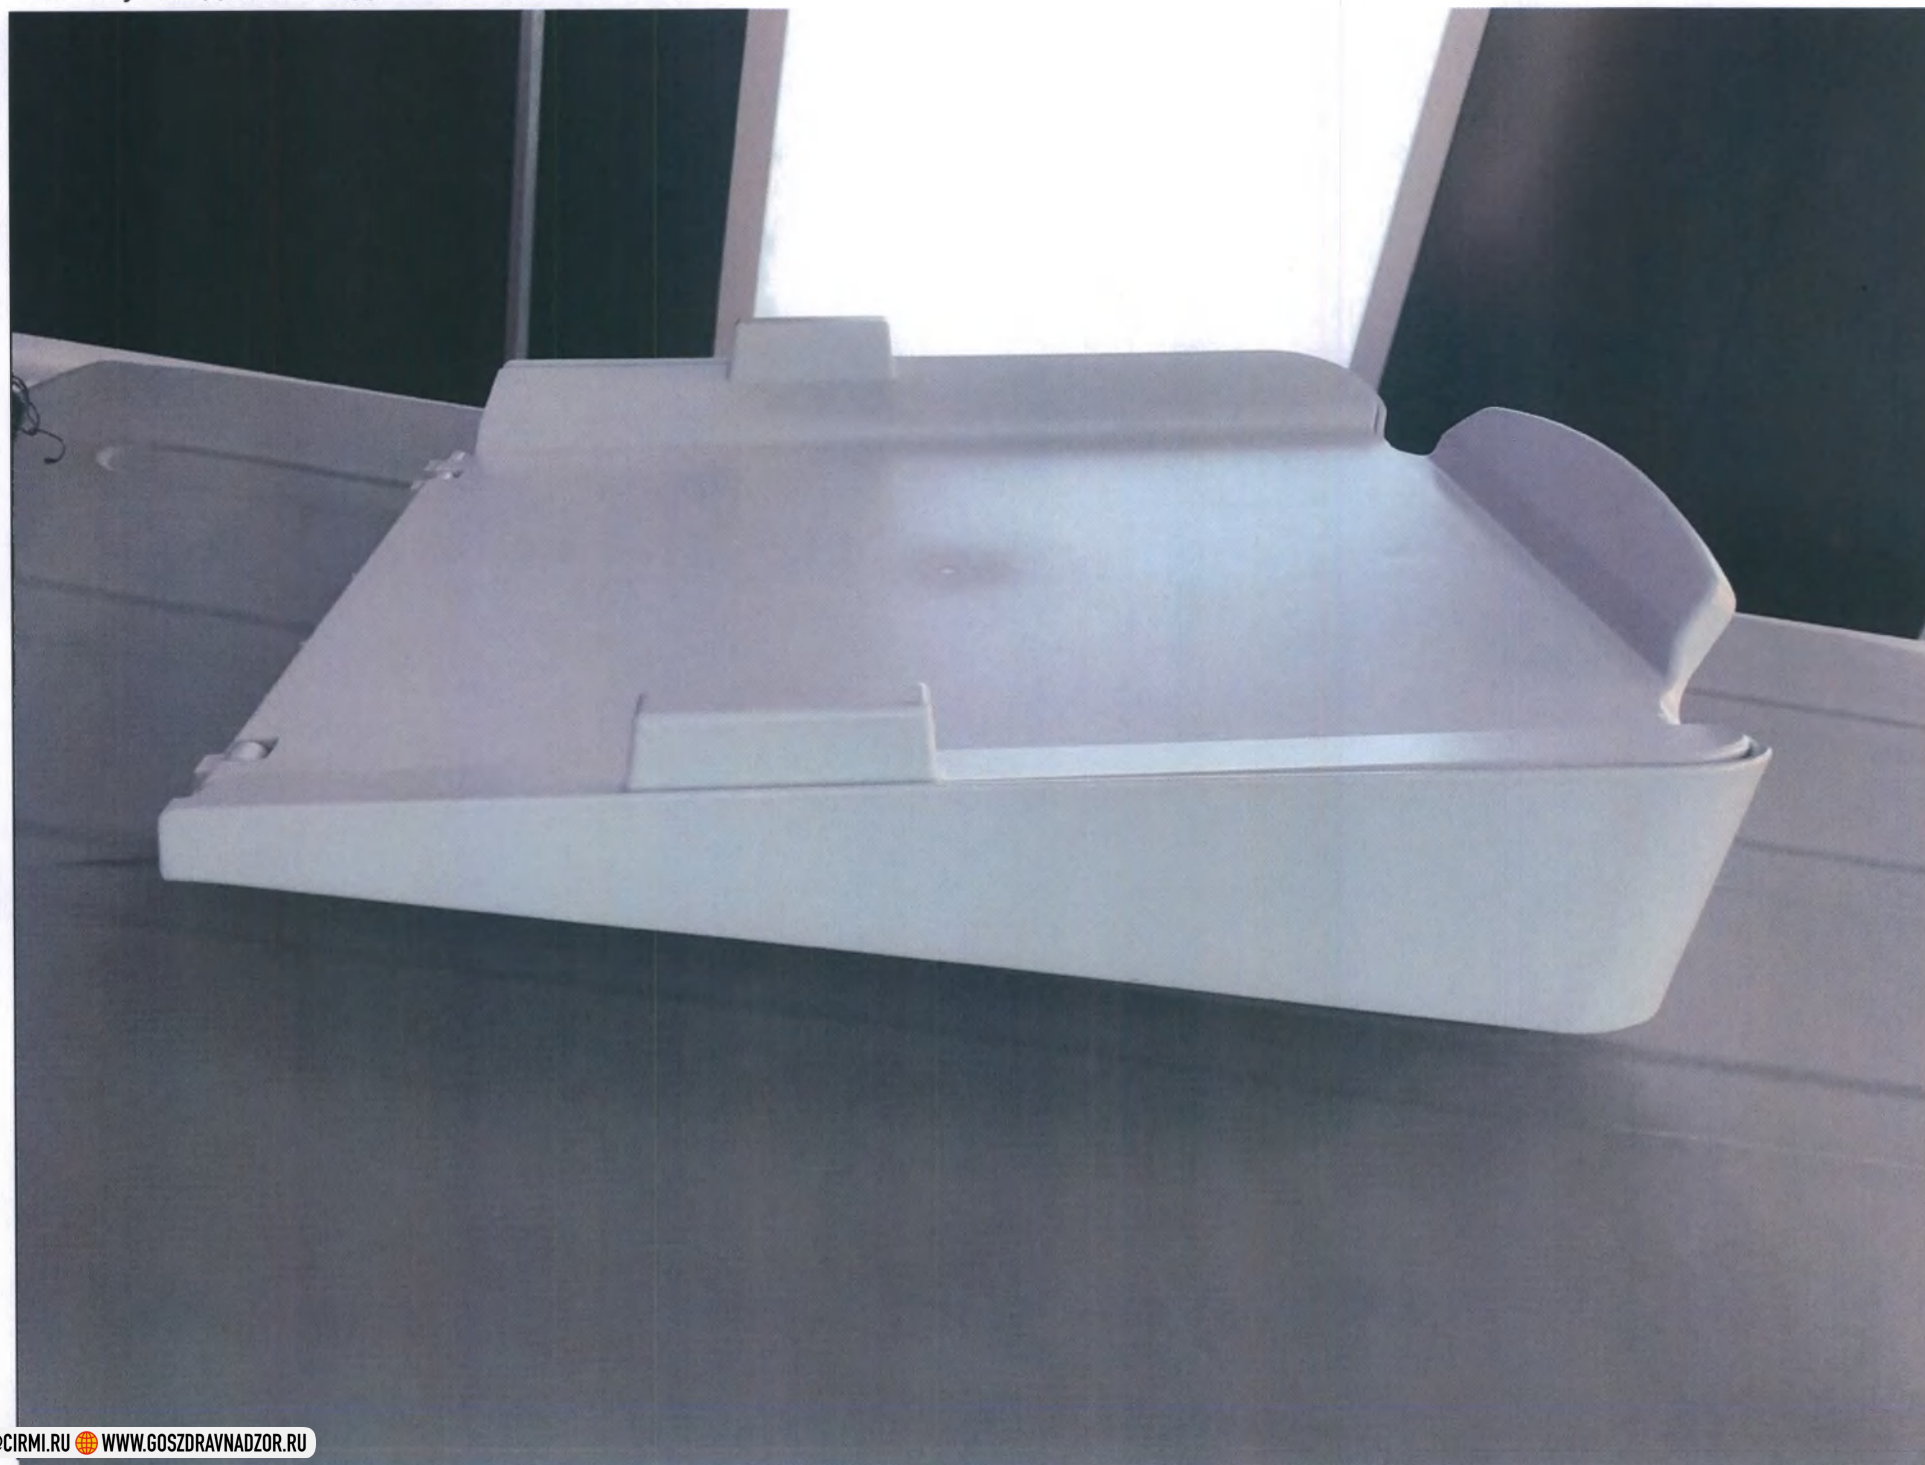


10. Катушки для исследования головы и шеи



11. Катушки для исследования молочных желез

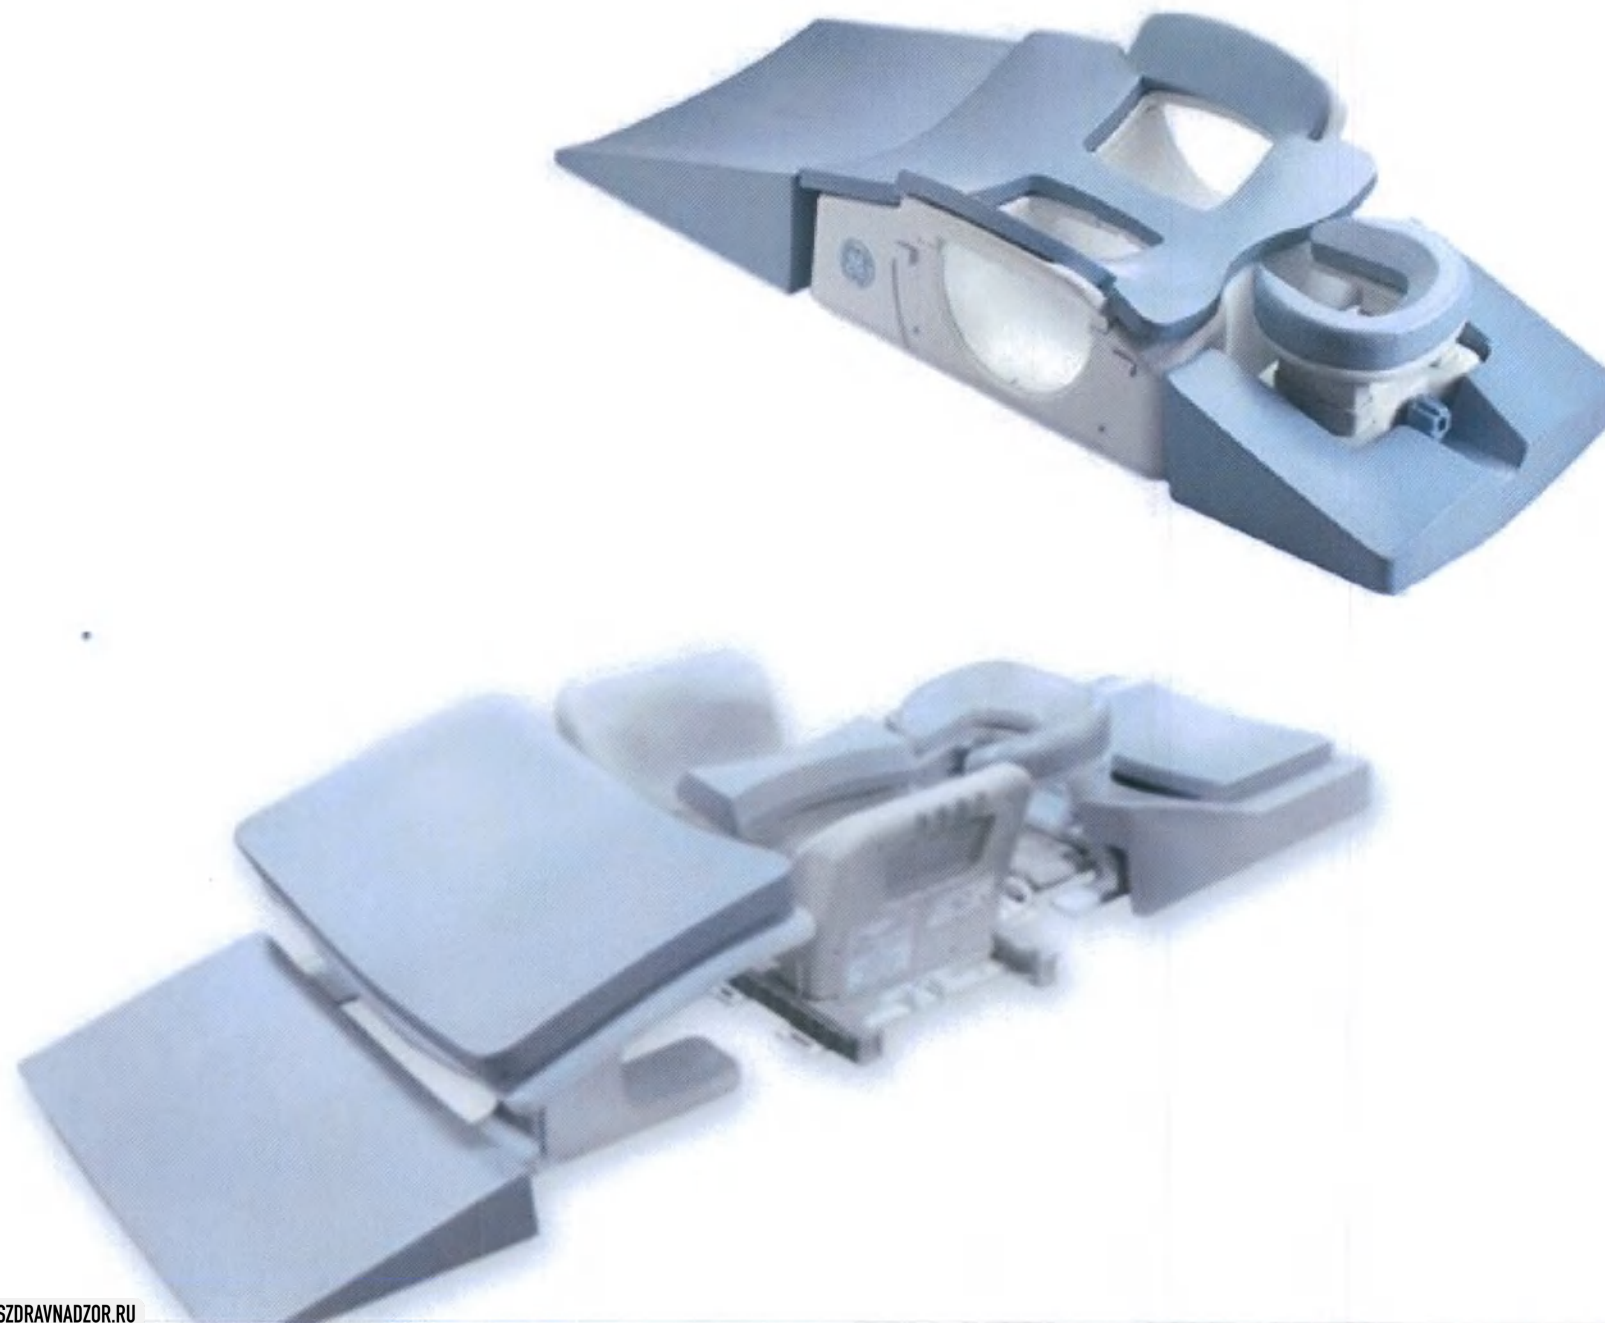

11. Катушки для исследования молочных желез

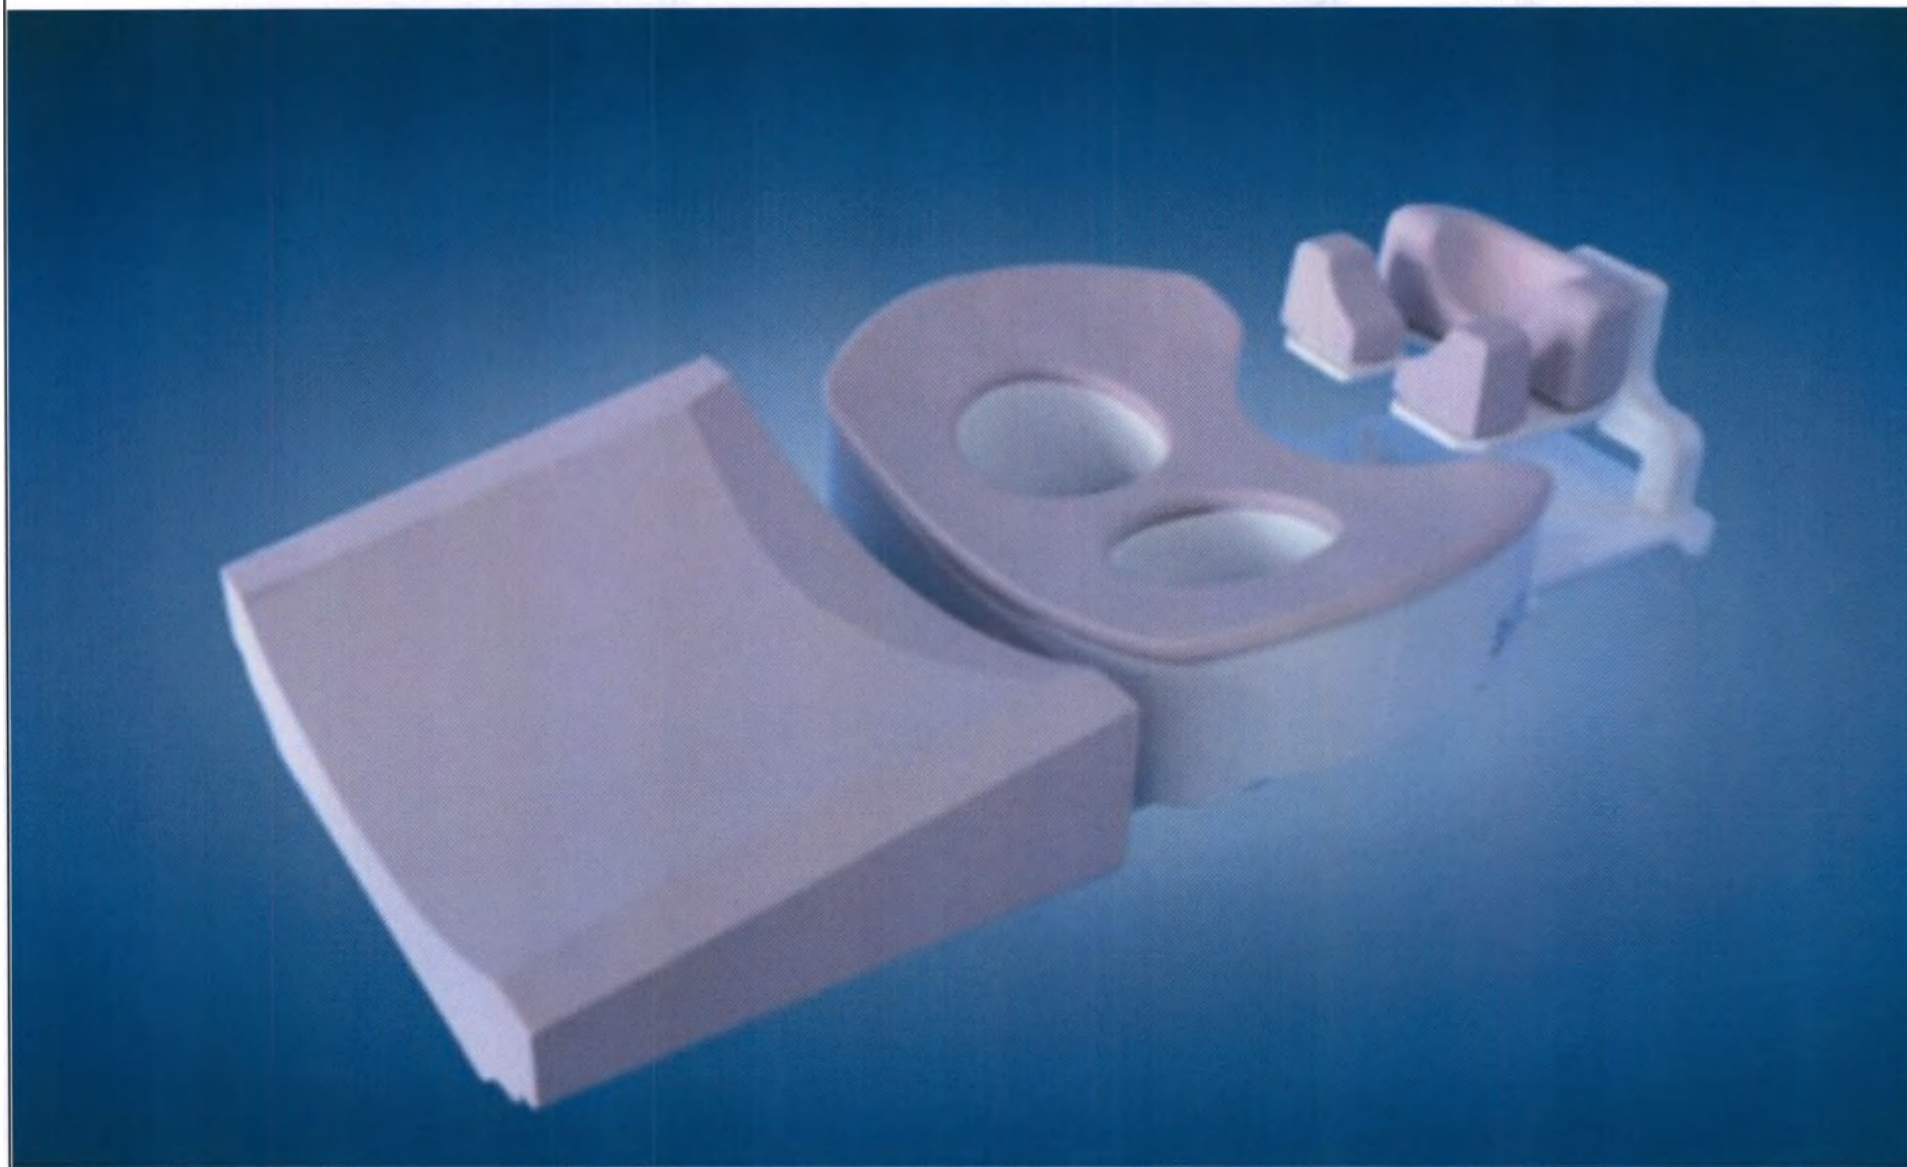

12. Катушки для исследования нижних конечностей



12. Катушки для исследования нижних конечностей




13. Катушки для исследования тела



13. Катушки для исследования тела



14. Устройство для позиционирования при биопсии к катушке для исследования молочных желез

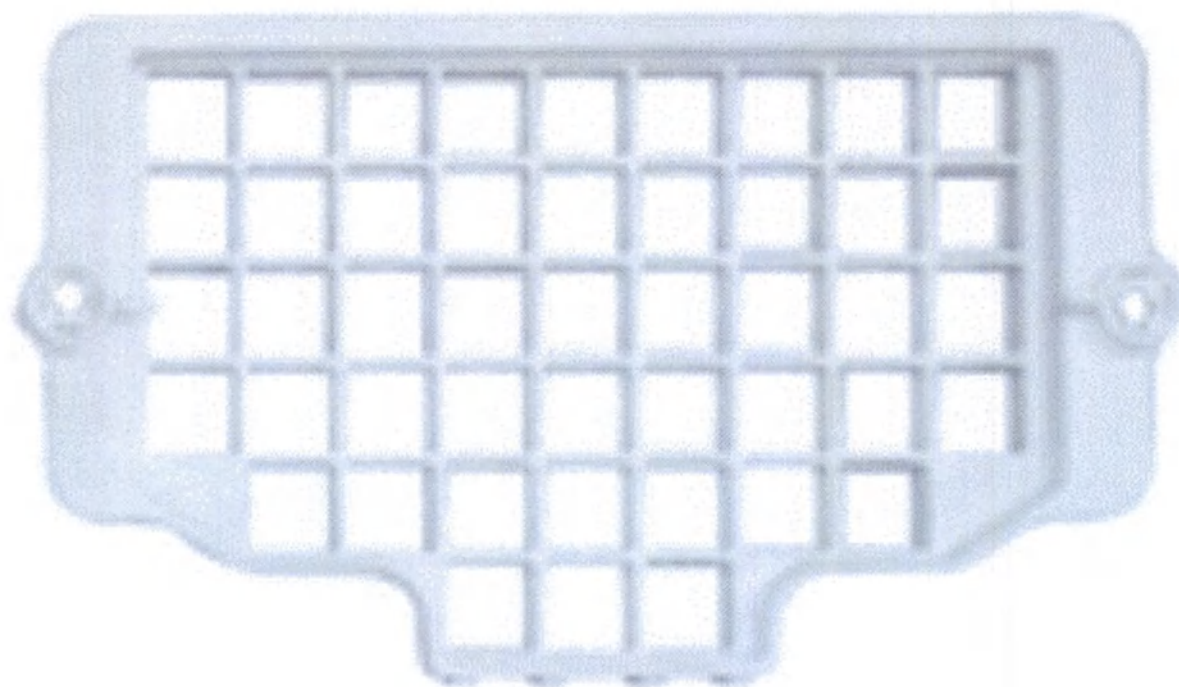


15. Катушка для исследования периферических сосудов



16. Катушки гибкие для исследования с технологией AIR



16. Катушки гибкие для исследования с технологией AIR

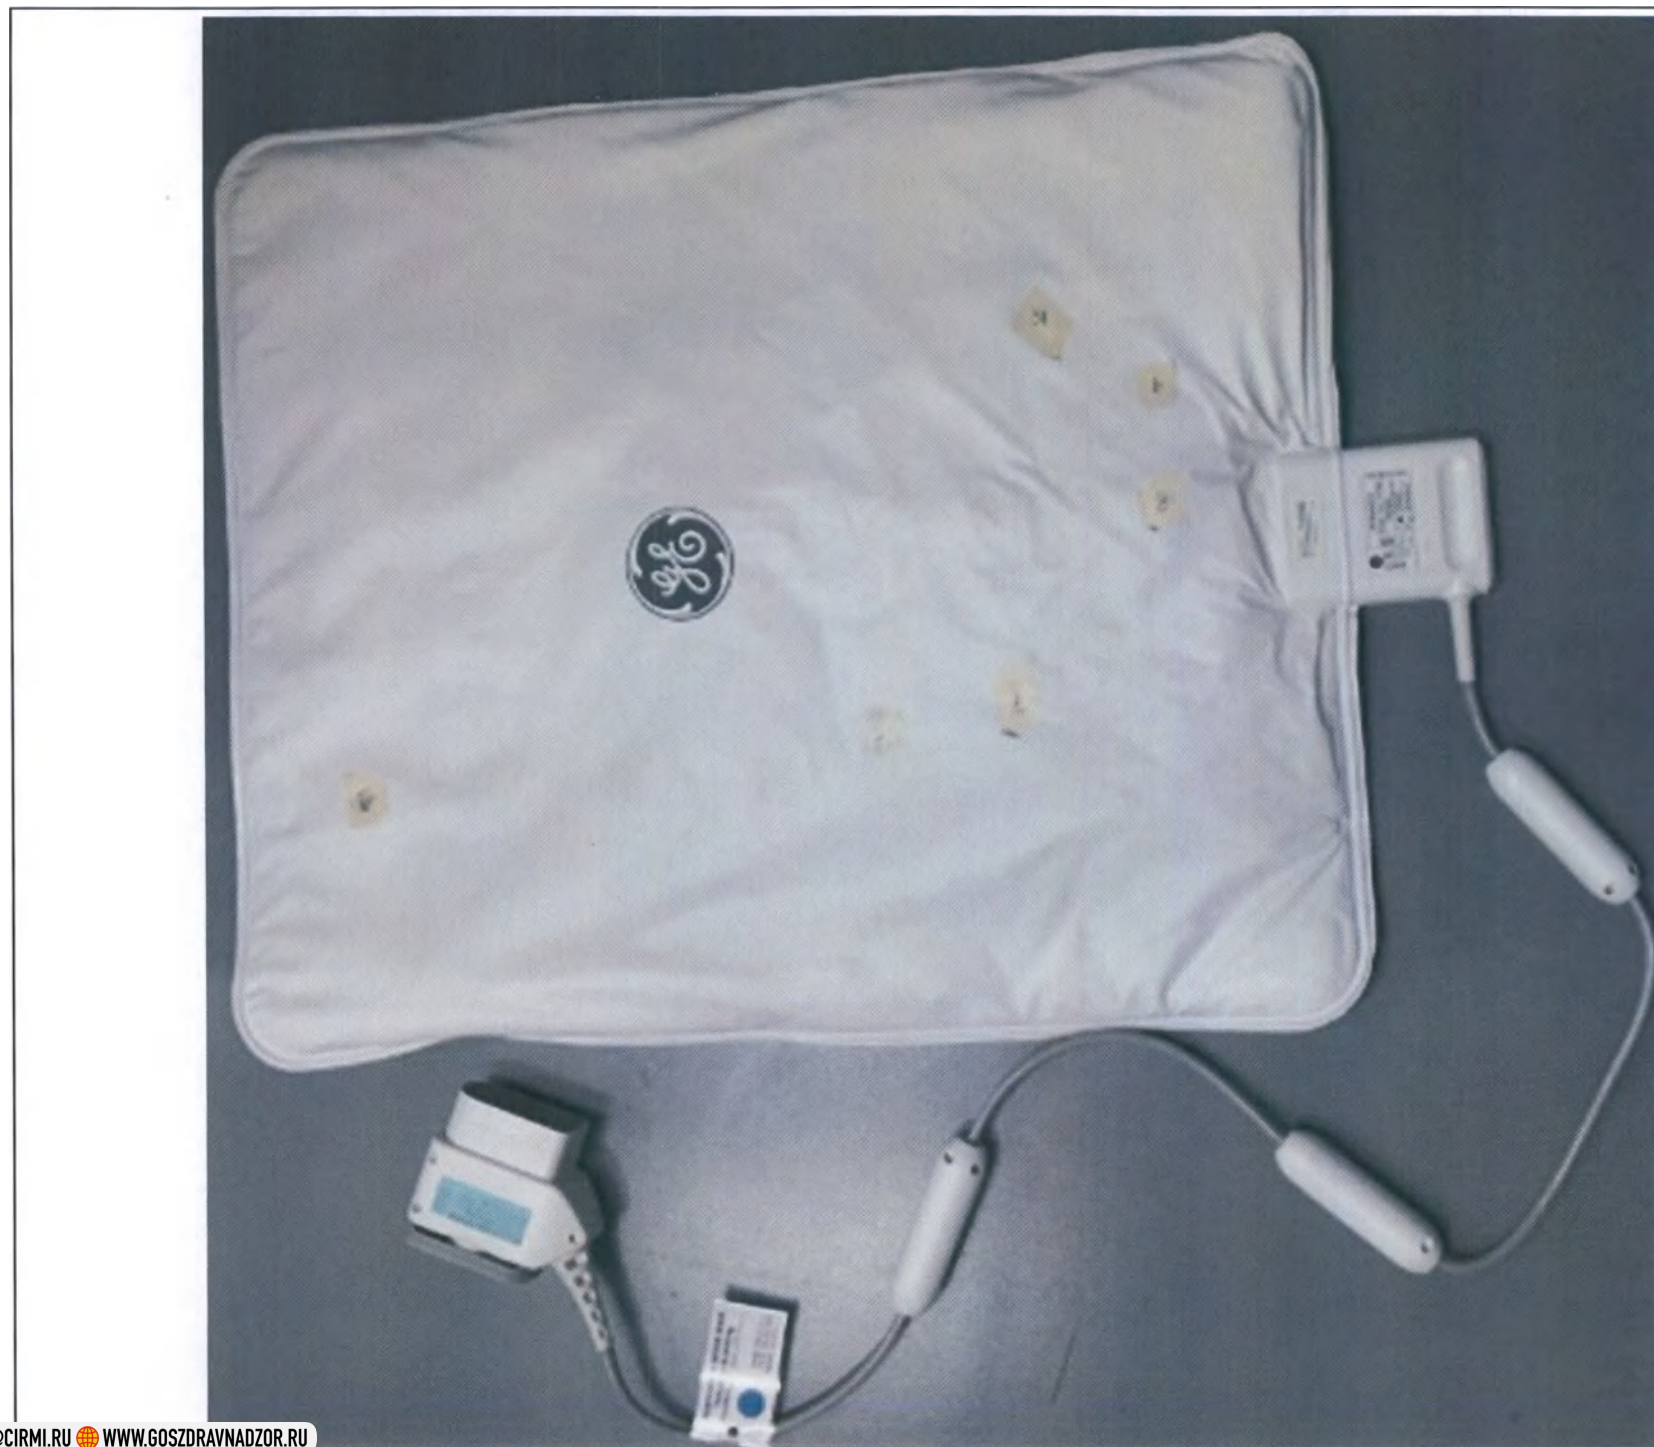

16. Катушки гибкие для исследования с технологией AIR



16. Катушки гибкие для исследования с технологией AIR




17. Клавиатуры специальные




18. Кожухи магнита




18. Кожухи магнита

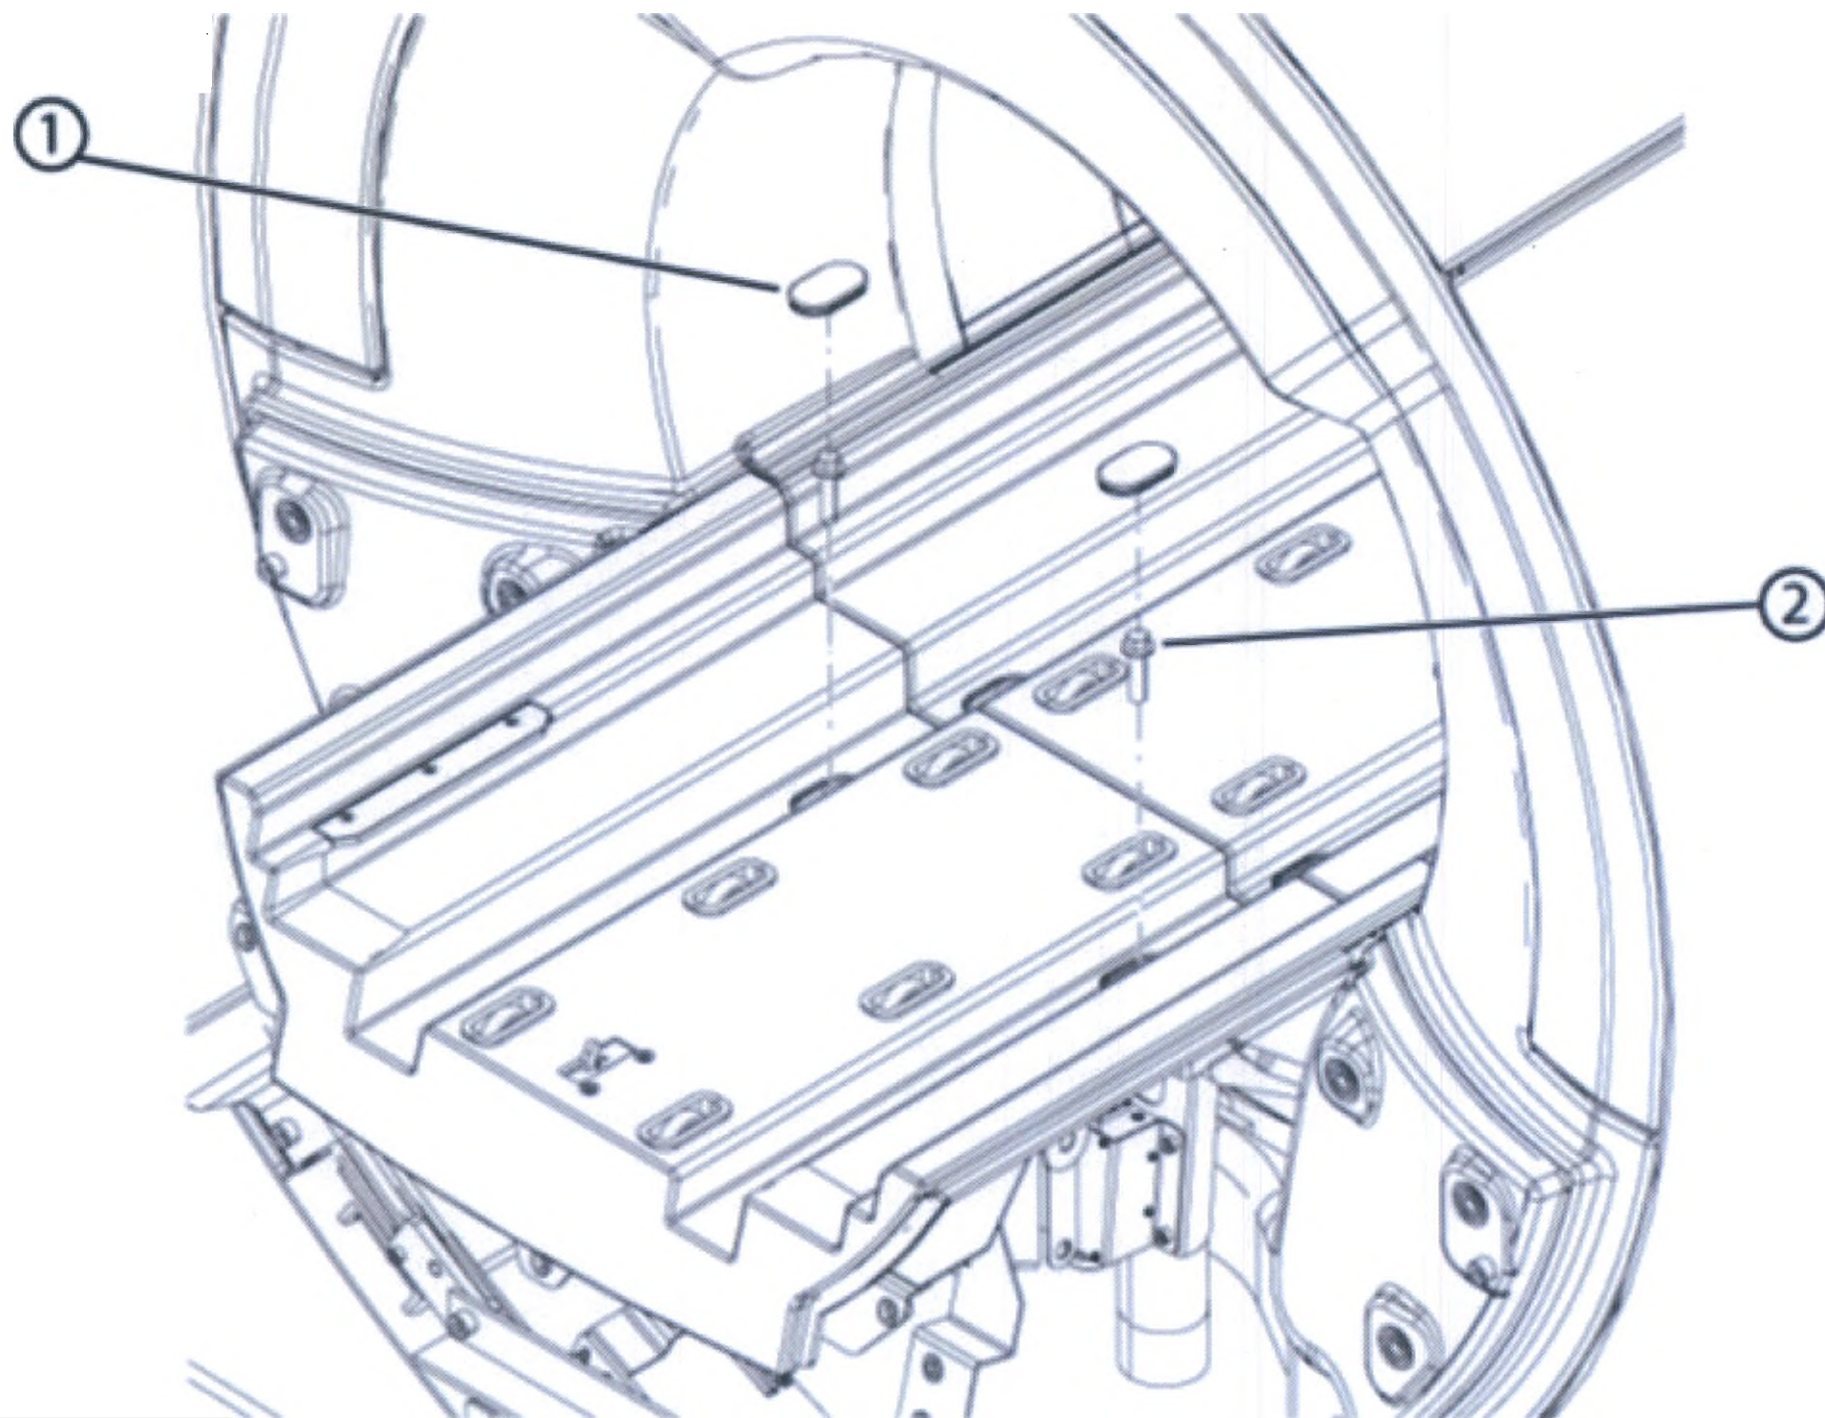


18. Кожухи магнита

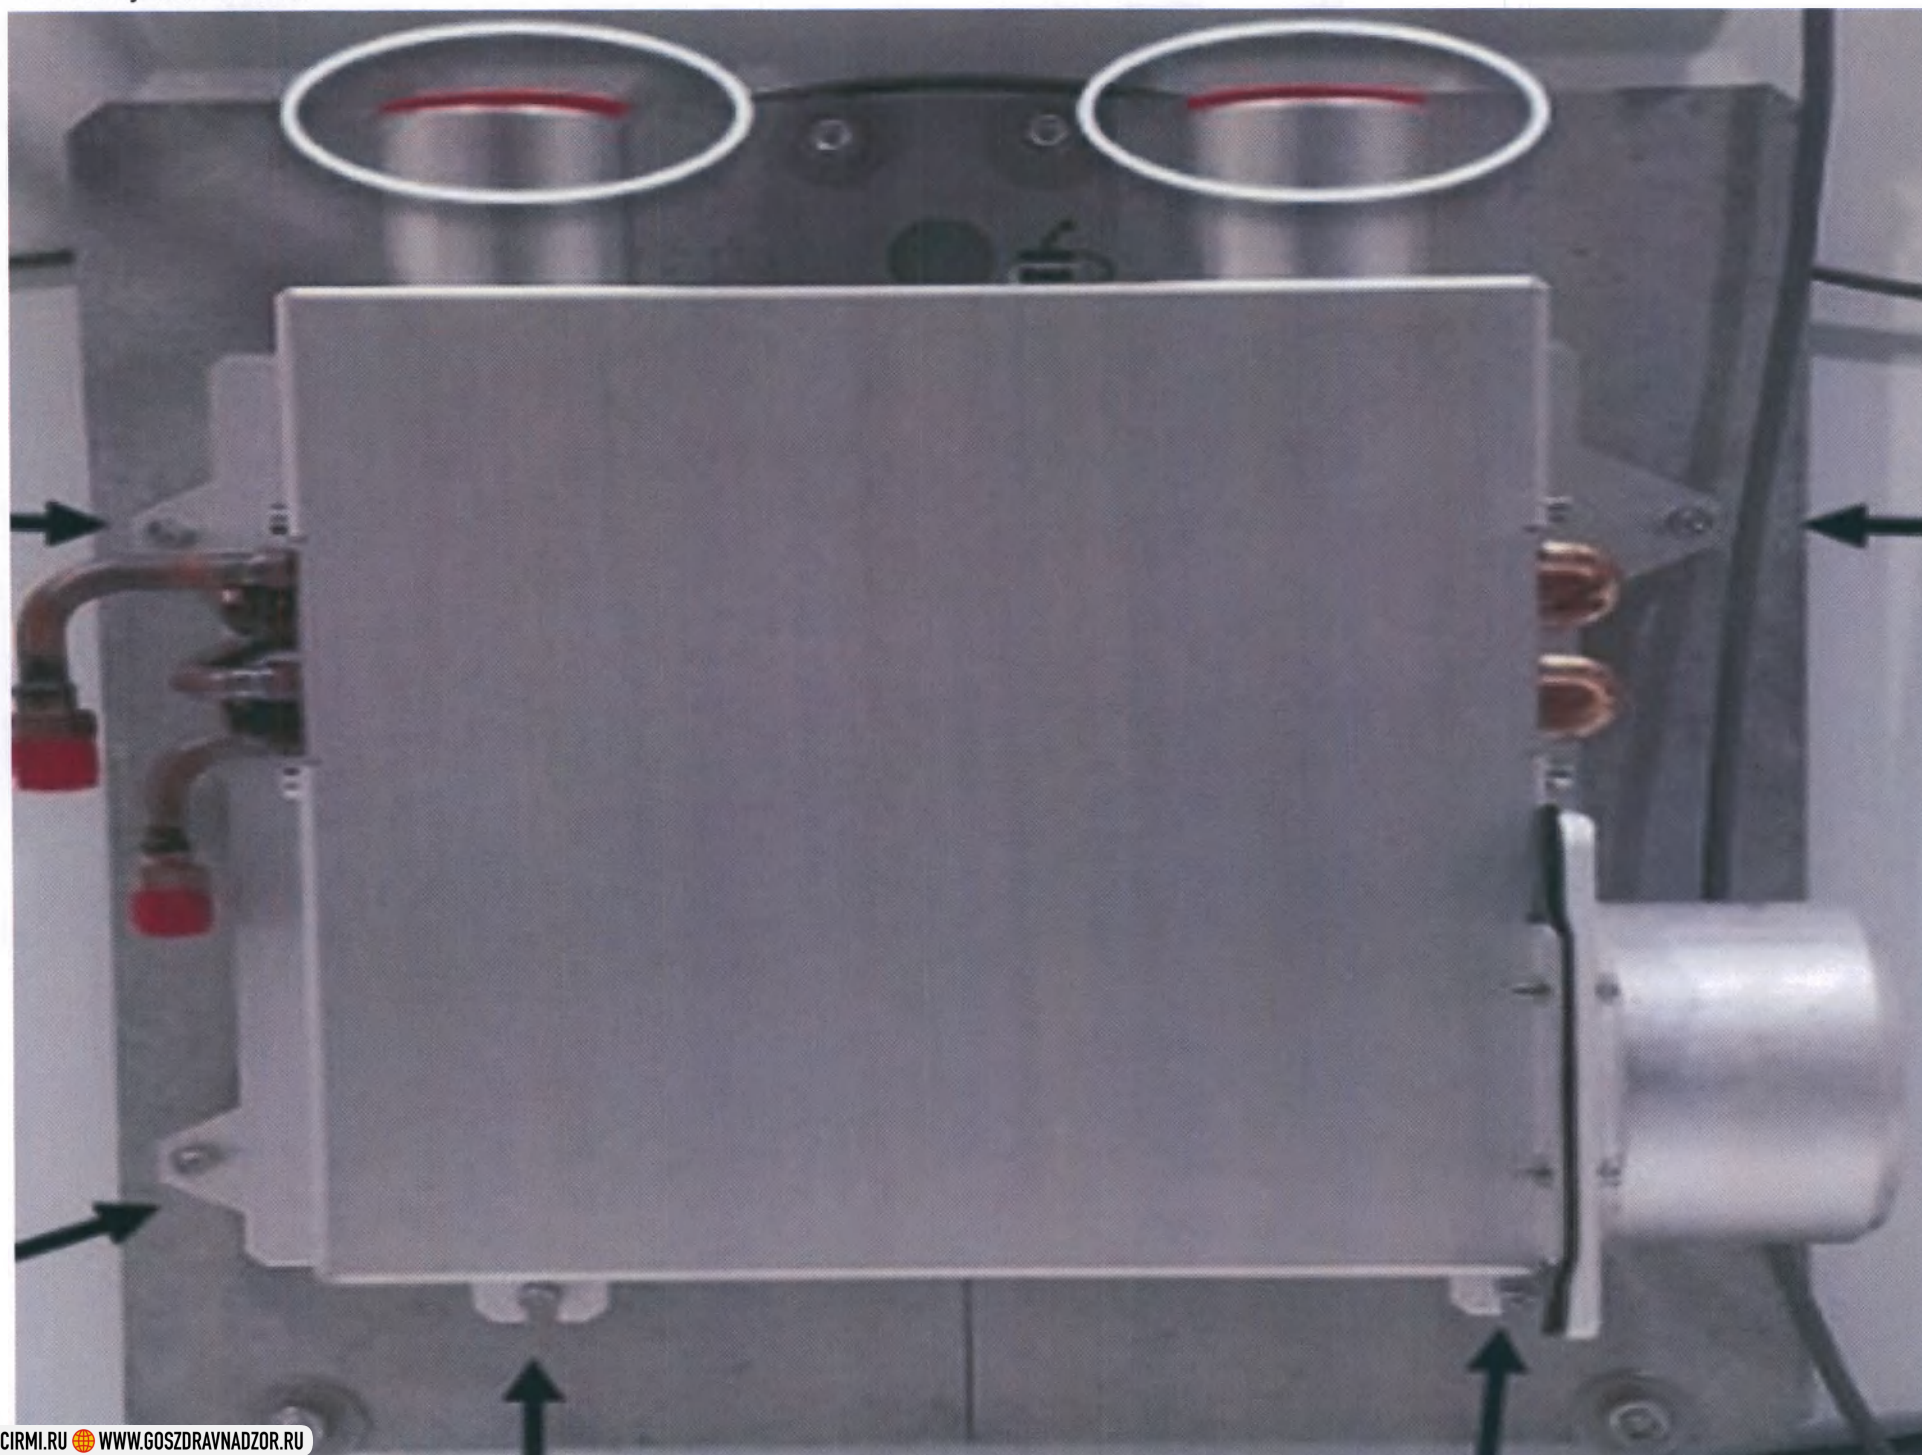


18. Кожухи магнита

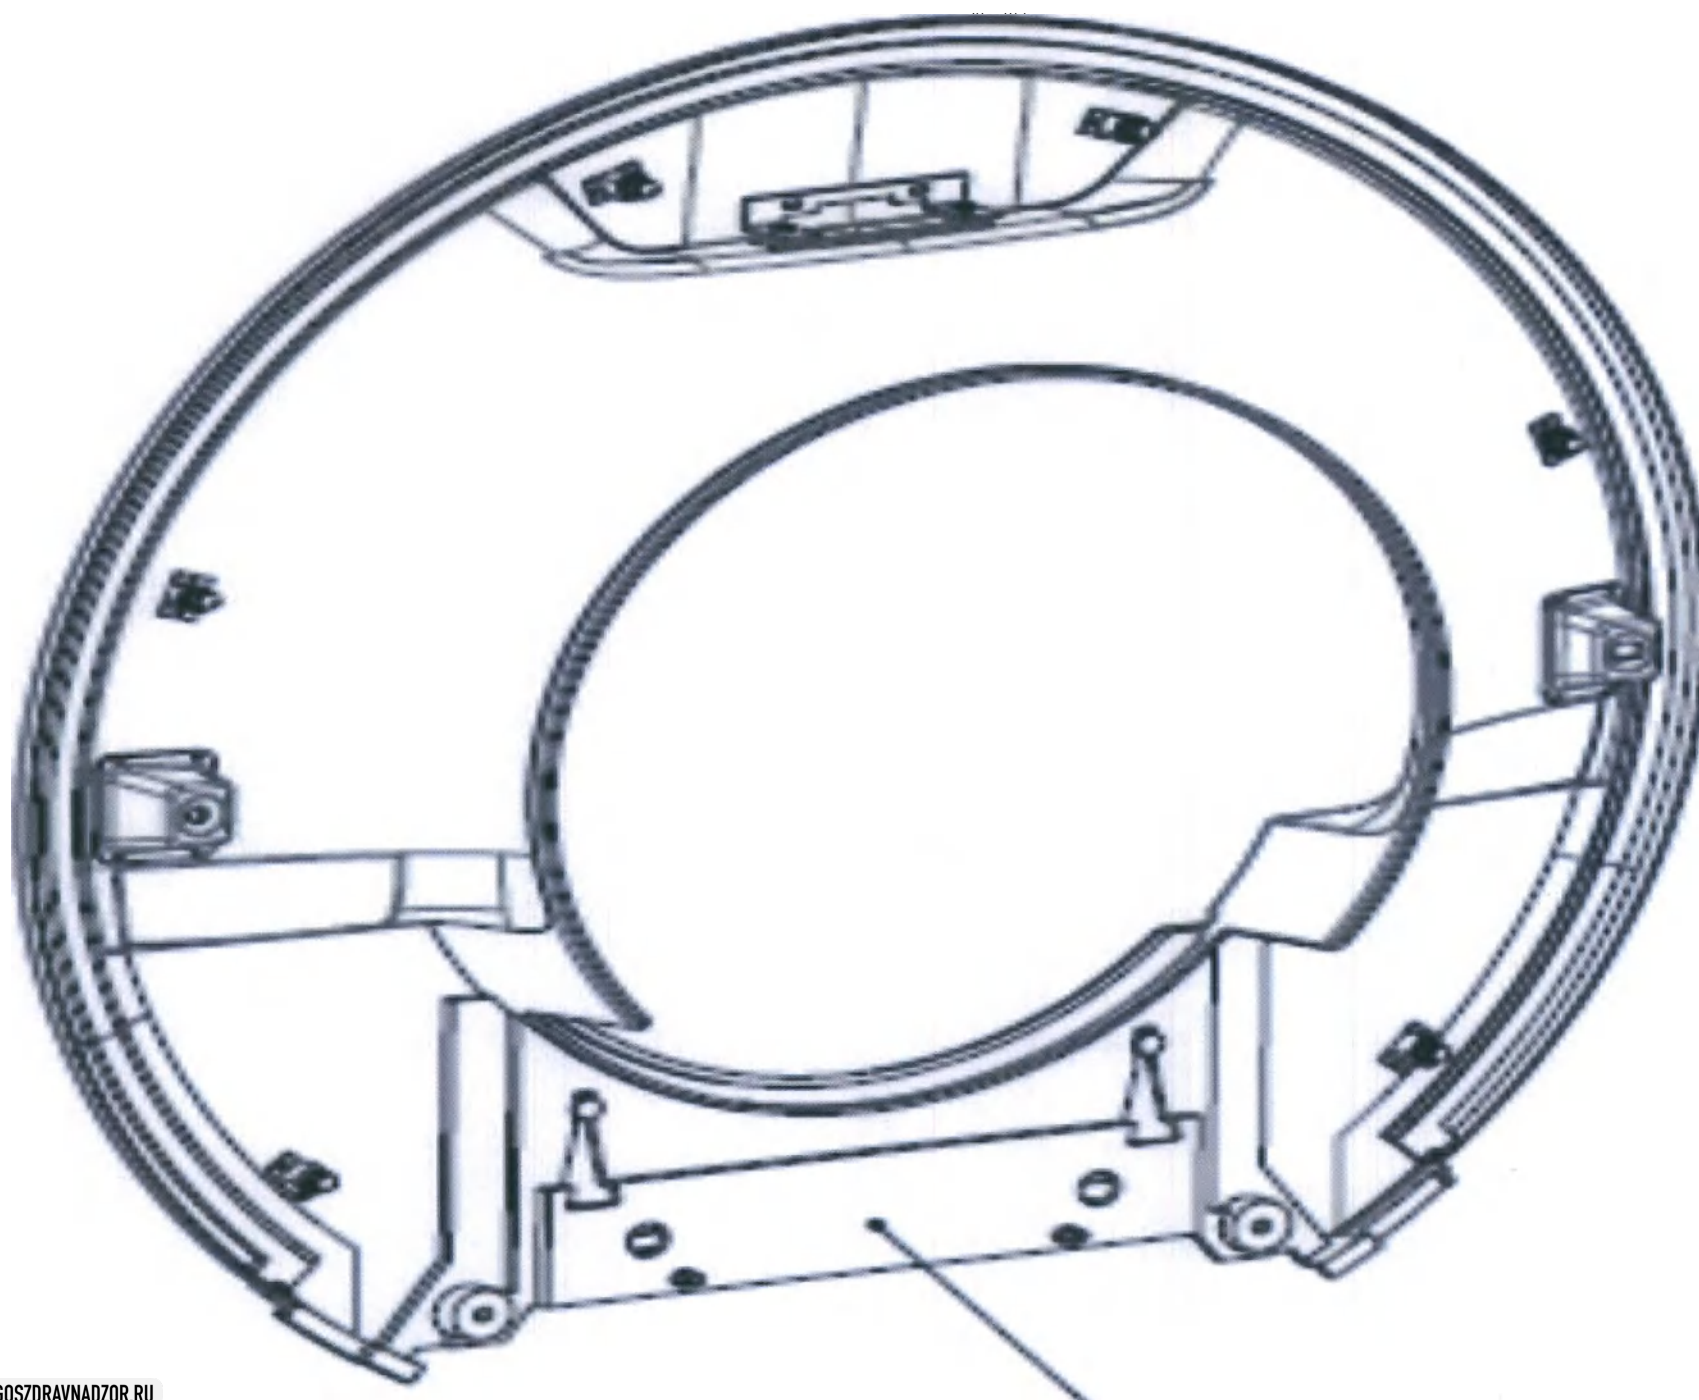


18. Кожухи магнита

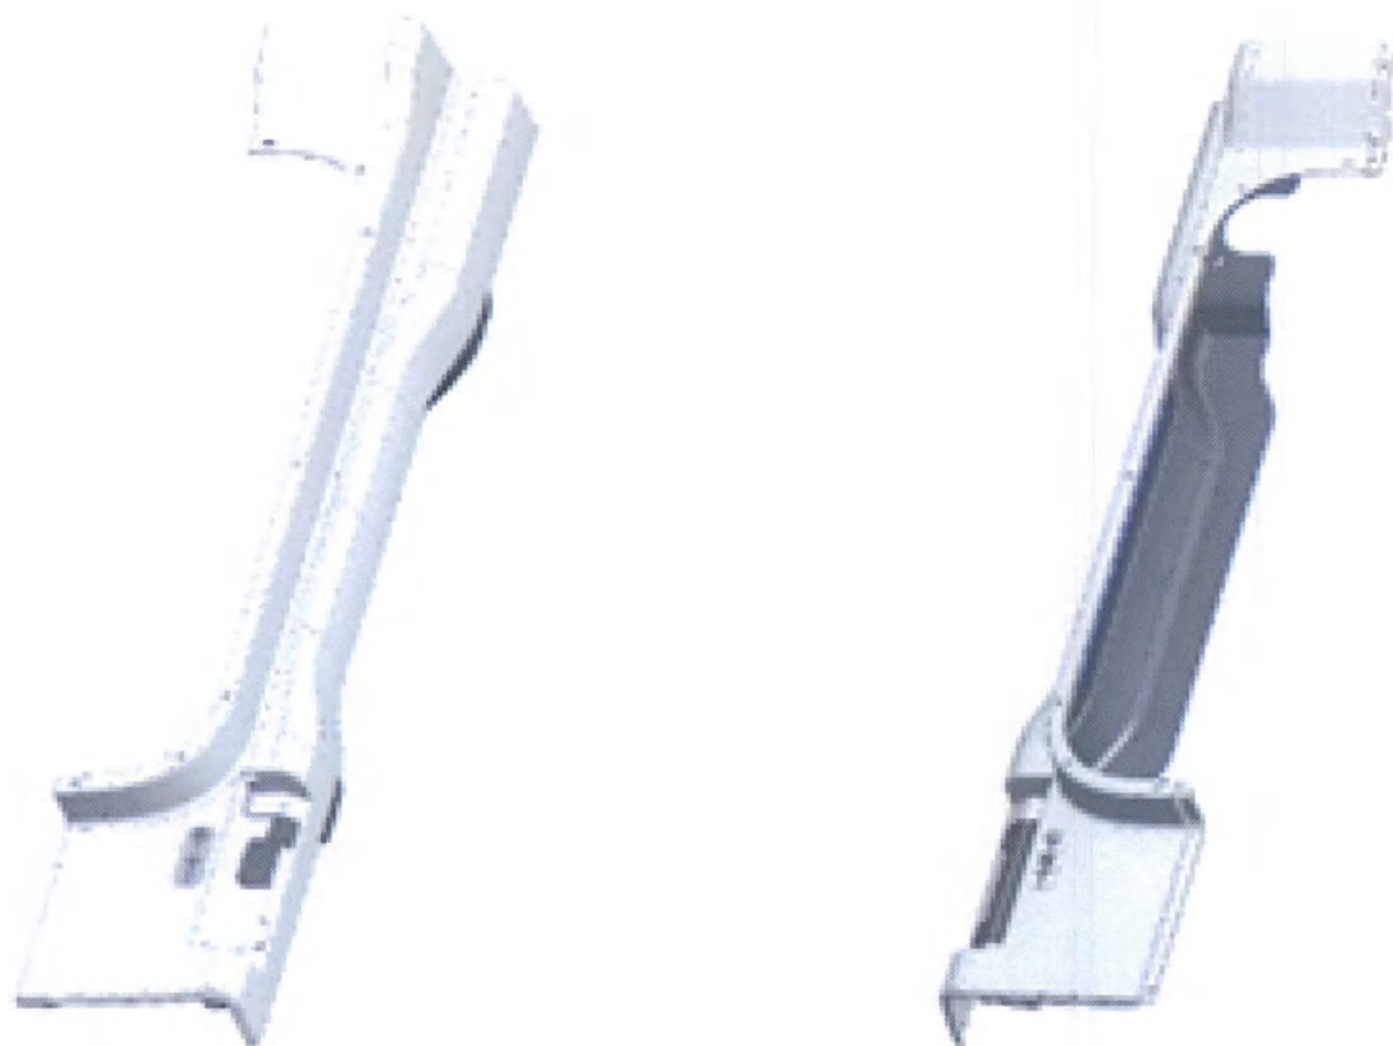


18. Кожухи магнита

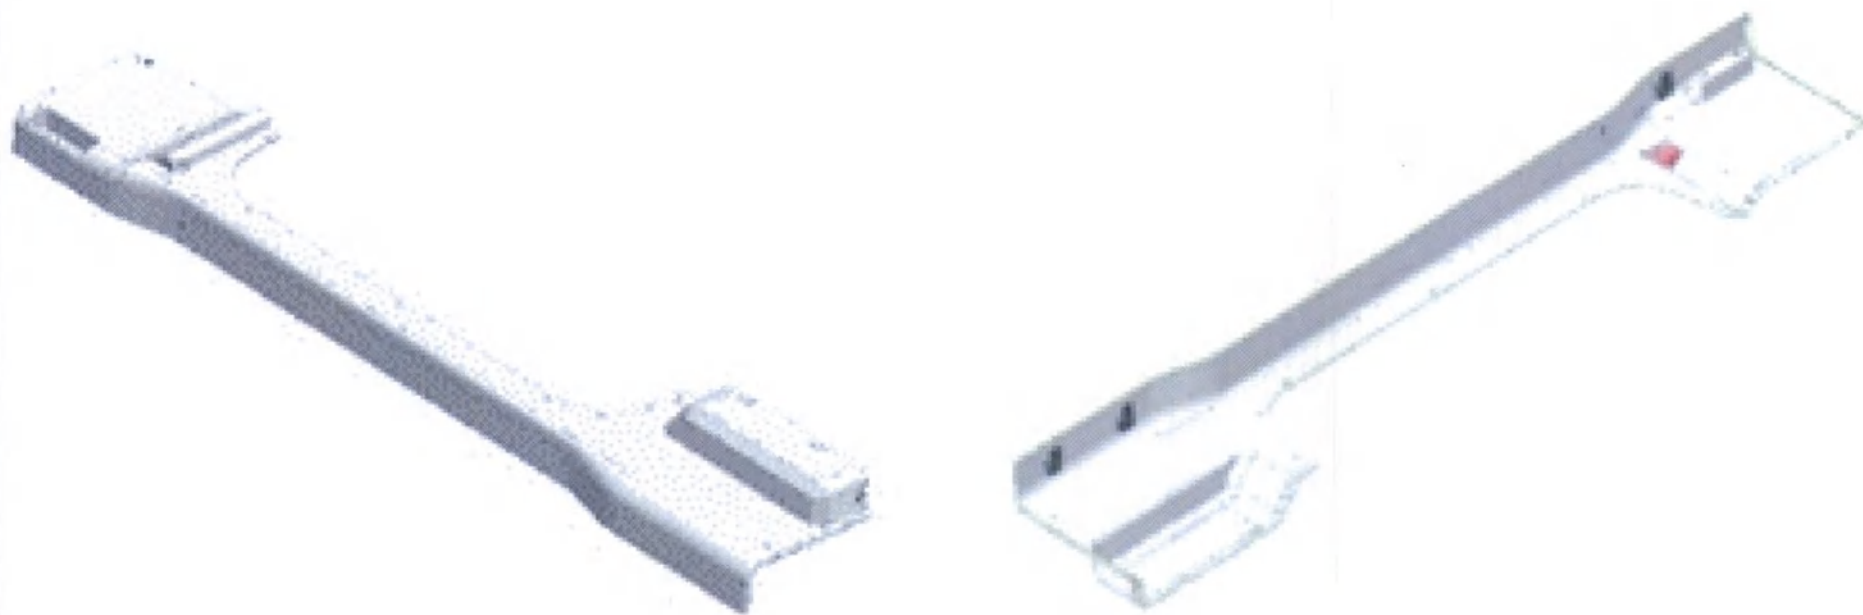

18. Кожухи магнита

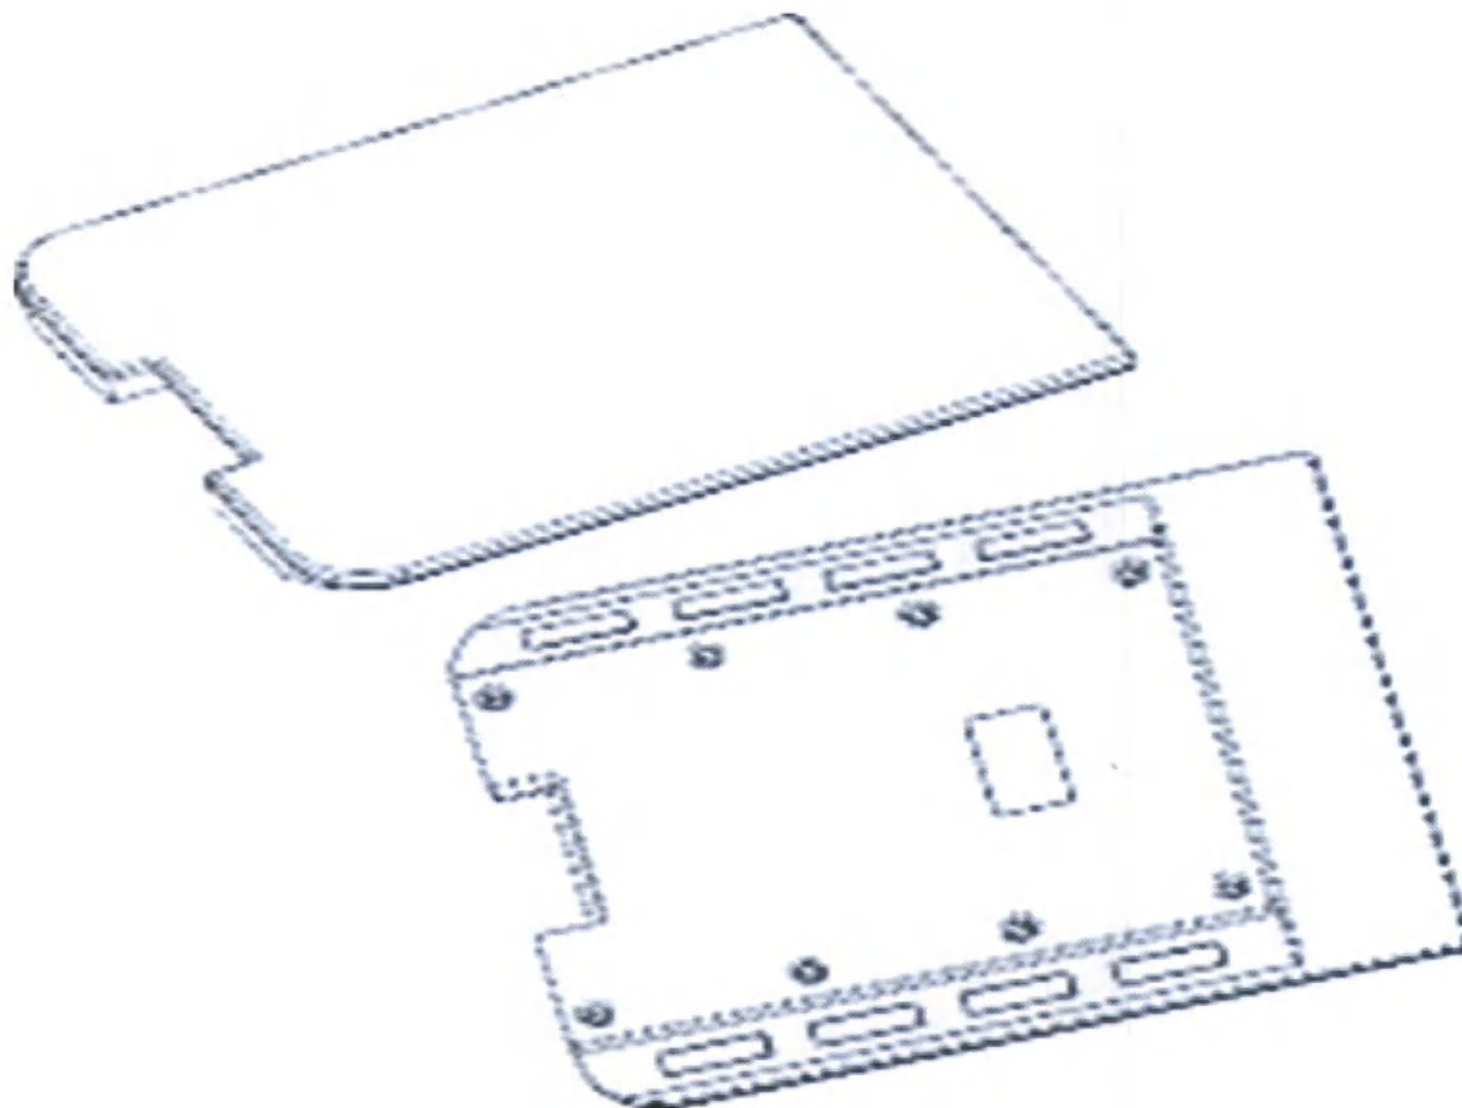



19. Комплекты предупредительных обозначений



WARNING



STRONG MAGNETIC FIELD



**NO PACEMAKERS
NO METALLIC IMPLANTS
NO NEUROSTIMULATORS**

Persons with pacemakers, neurostimulators, or
metallic implants must not enter this area.
Serious injury may result.



ОСТОРОЖНО!

ОПАСНОСТЬ УДУШЬЯ


Звуковой сигнал тревоги свидетельствует
о низком уровне кислорода.

Весь персонал должен эвакуироваться из
помещения с моментом до восстановления
безопасного уровня кислорода.



WARNING

3.0T MAGNET

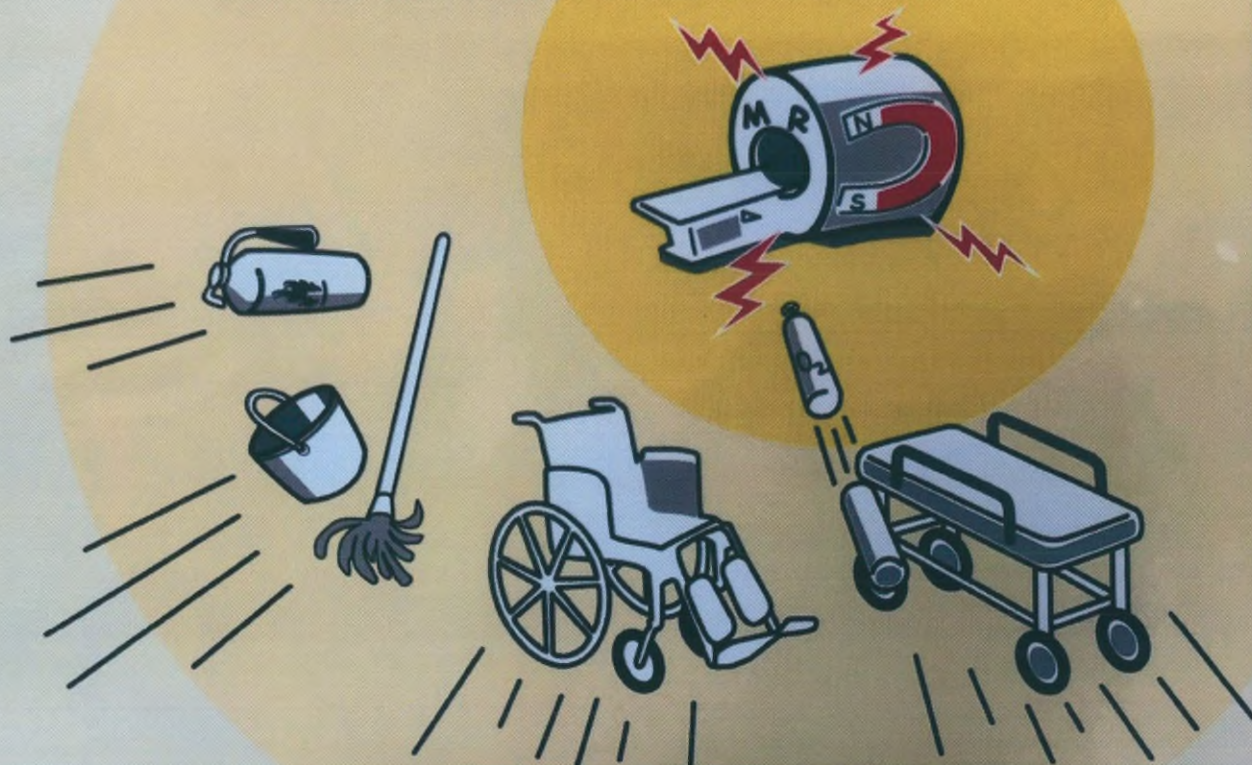

STRONG MAGNETIC FIELD
Magnet is Always on



HEARING PROTECTION REQUIRED

During a scan, all persons in the scan room are required to wear hearing protection to avoid possible hearing impairment.



NO PACEMAKERS*

NO NEUROSTIMULATORS*

NO CONDUCTIVE/METALLIC IMPLANTS*

Persons with pacemakers, neurostimulators or metallic implants must not enter this area. Serious injury may result.



NO LOOSE METAL OBJECTS

Iron, steel and other ferrous materials must not be taken into this area. Serious injury or property damage may result.



RISK OF NON-IONIZING RADIATION

If scan is performed with magnet room open.

* In general, patients with conductive (e.g. metallic) implants are contraindicated for MR scans. For patients with implants that are labeled as 'MR Safe' or 'MR Conditional', consult the implant device manufacturer's documentation...

* WARNING: Only use quadrature transmit for 'MR Conditional' devices.

5455191

20. Контейнеры для транспортировки магнита






21. Мониторы кислорода




21. Мониторы кислорода

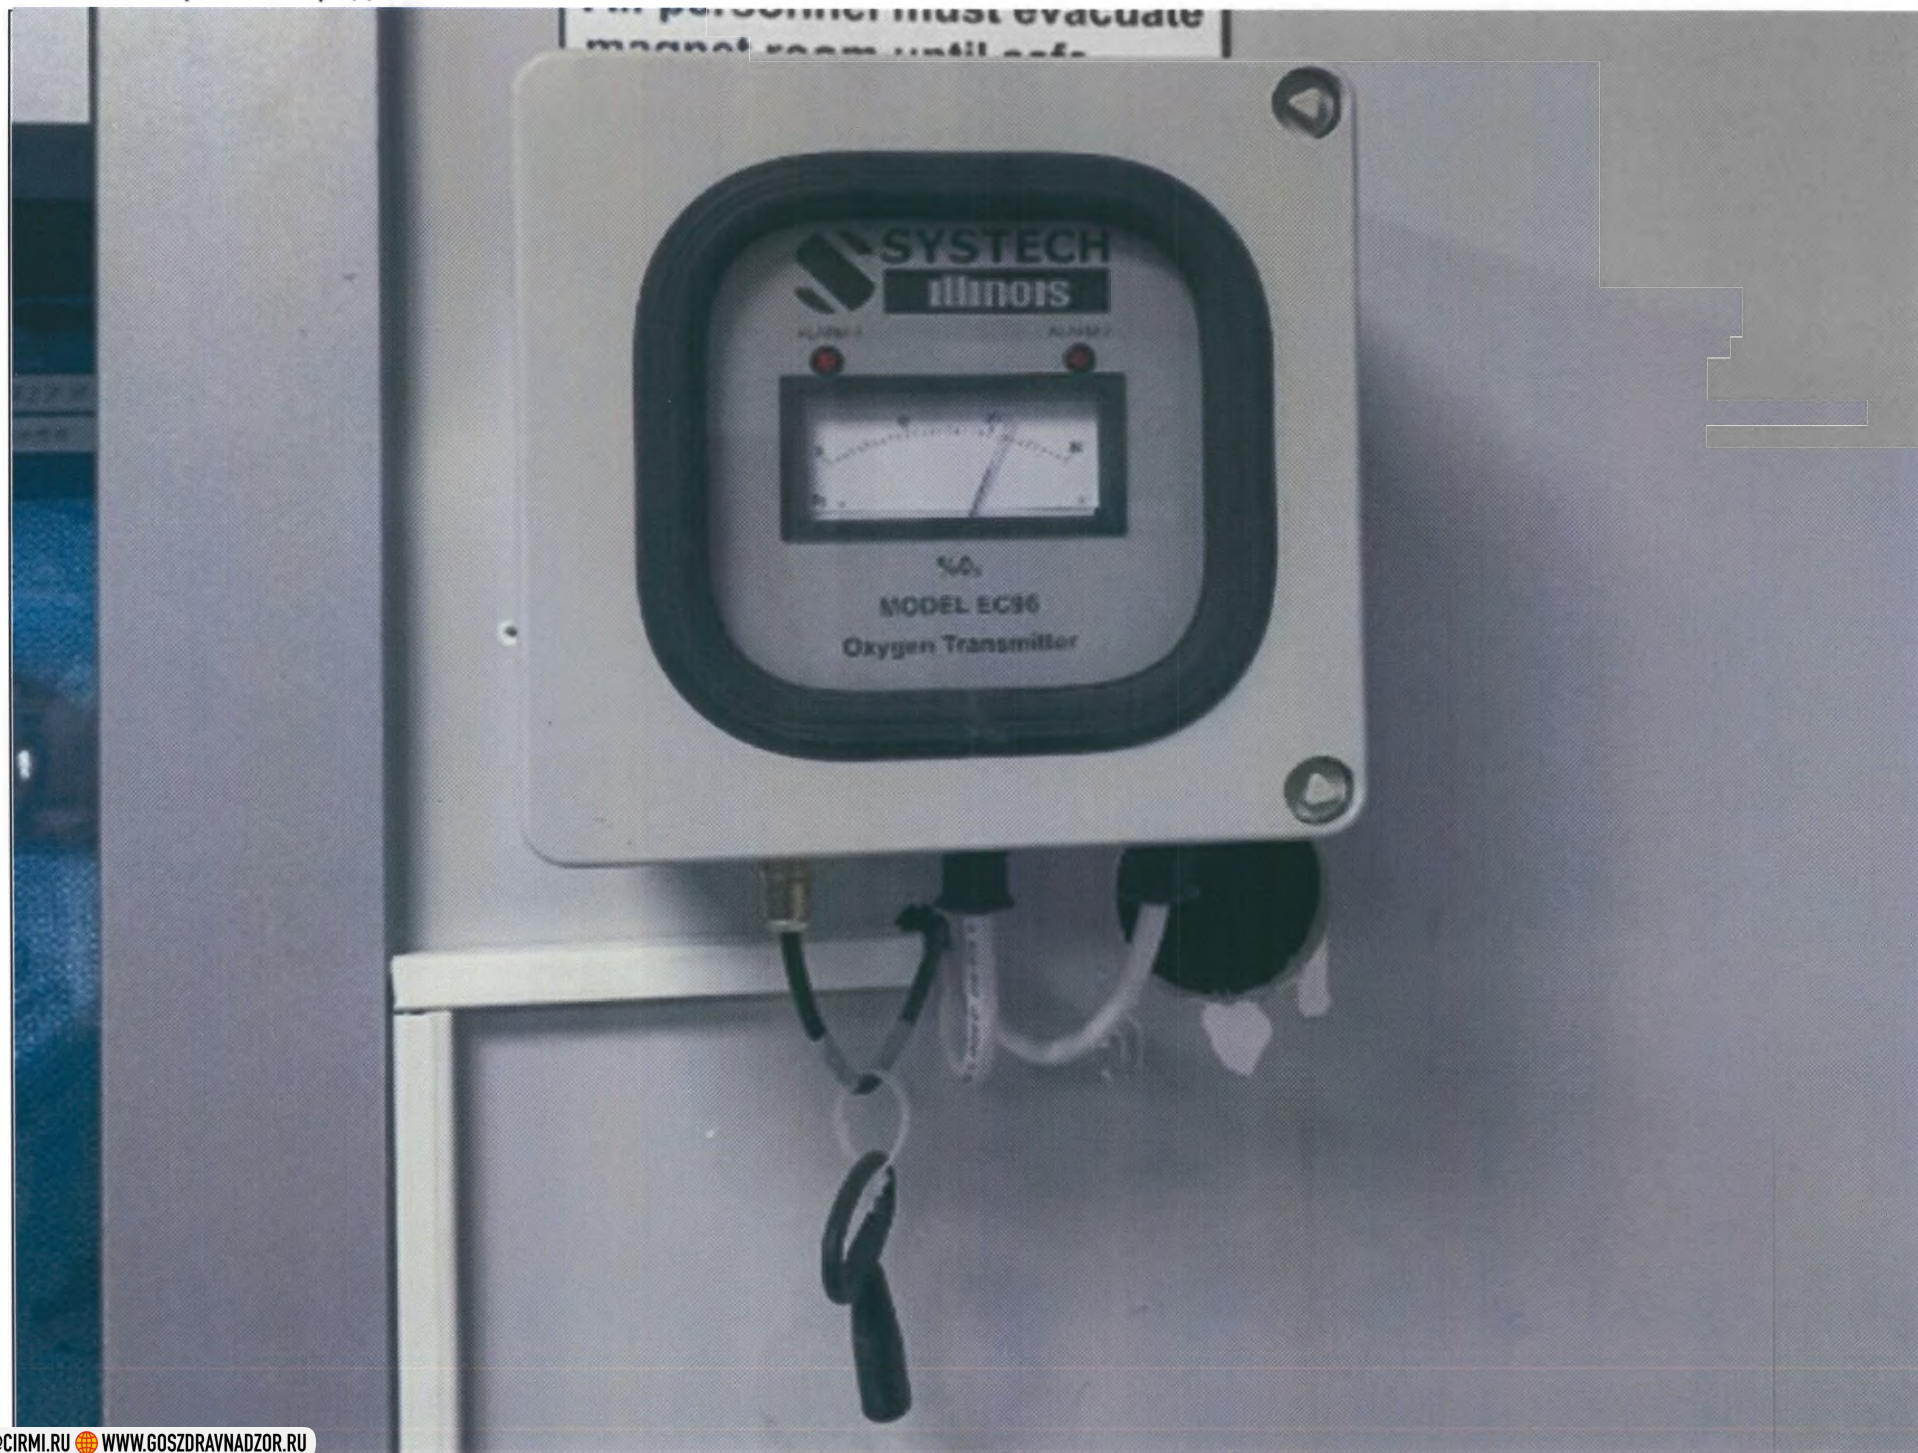

21. Мониторы кислорода



22. Устройство для проведения функциональной МРТ

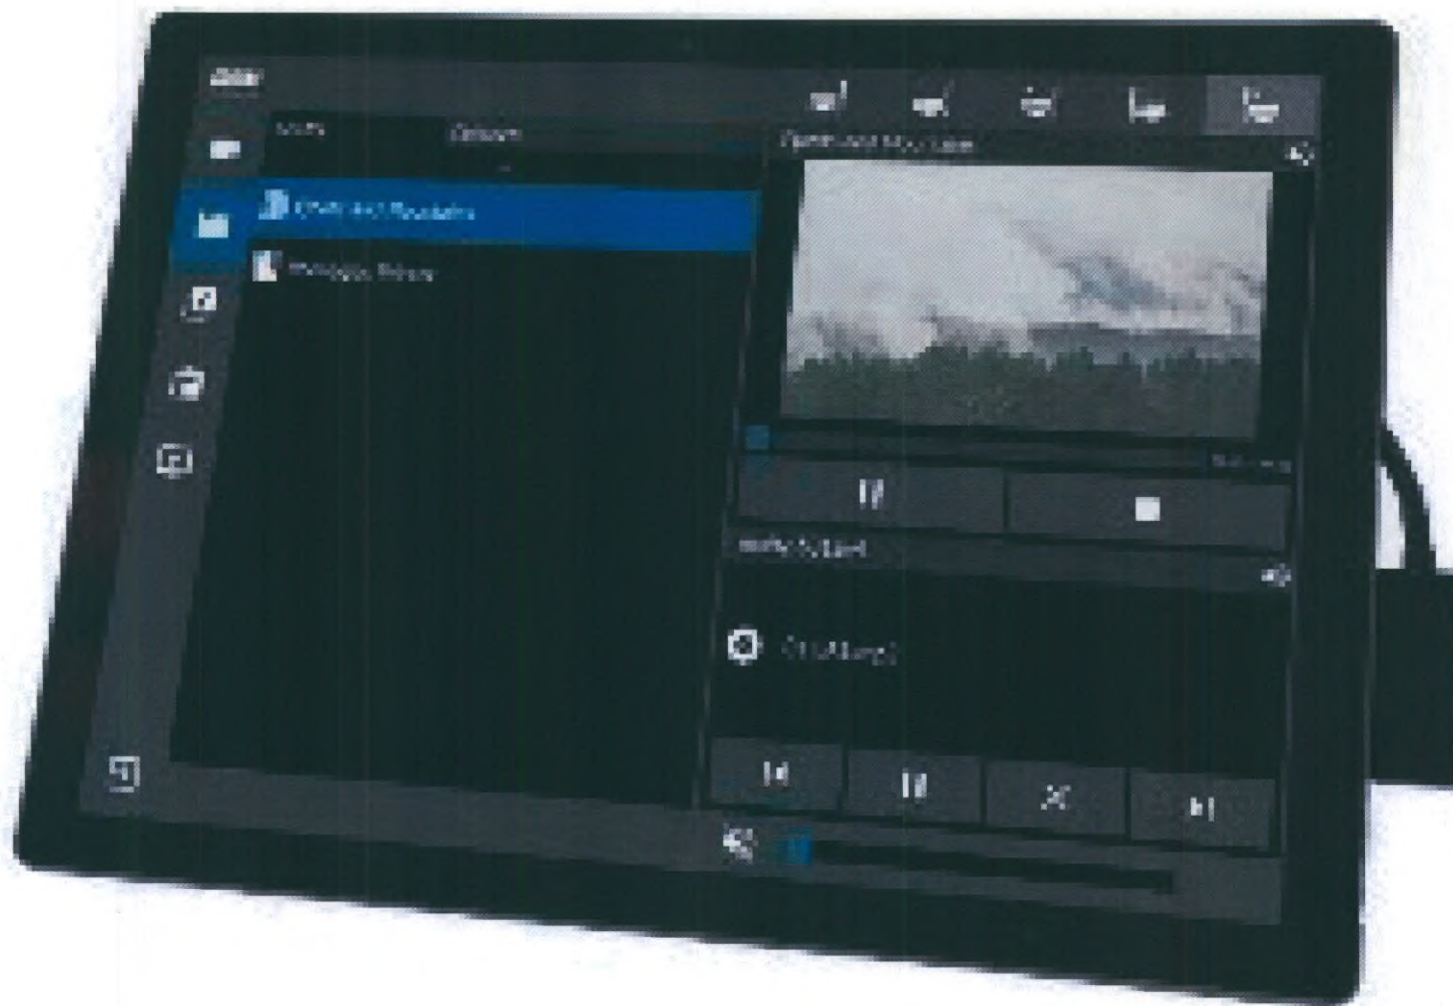

22. Устройство для проведения функциональной МРТ



22. Устройство для проведения функциональной МРТ



22. Устройство для проведения функциональной МРТ



22. Устройство для проведения функциональной МРТ



22. Устройство для проведения функциональной МРТ



23. Система видеонаблюдения



23. Система видеонаблюдения




24. МРТ-совместимое видеоустройство для комфорта пациента




25. МРТ совместимый монитор пациента



25. МРТ совместимый монитор пациента

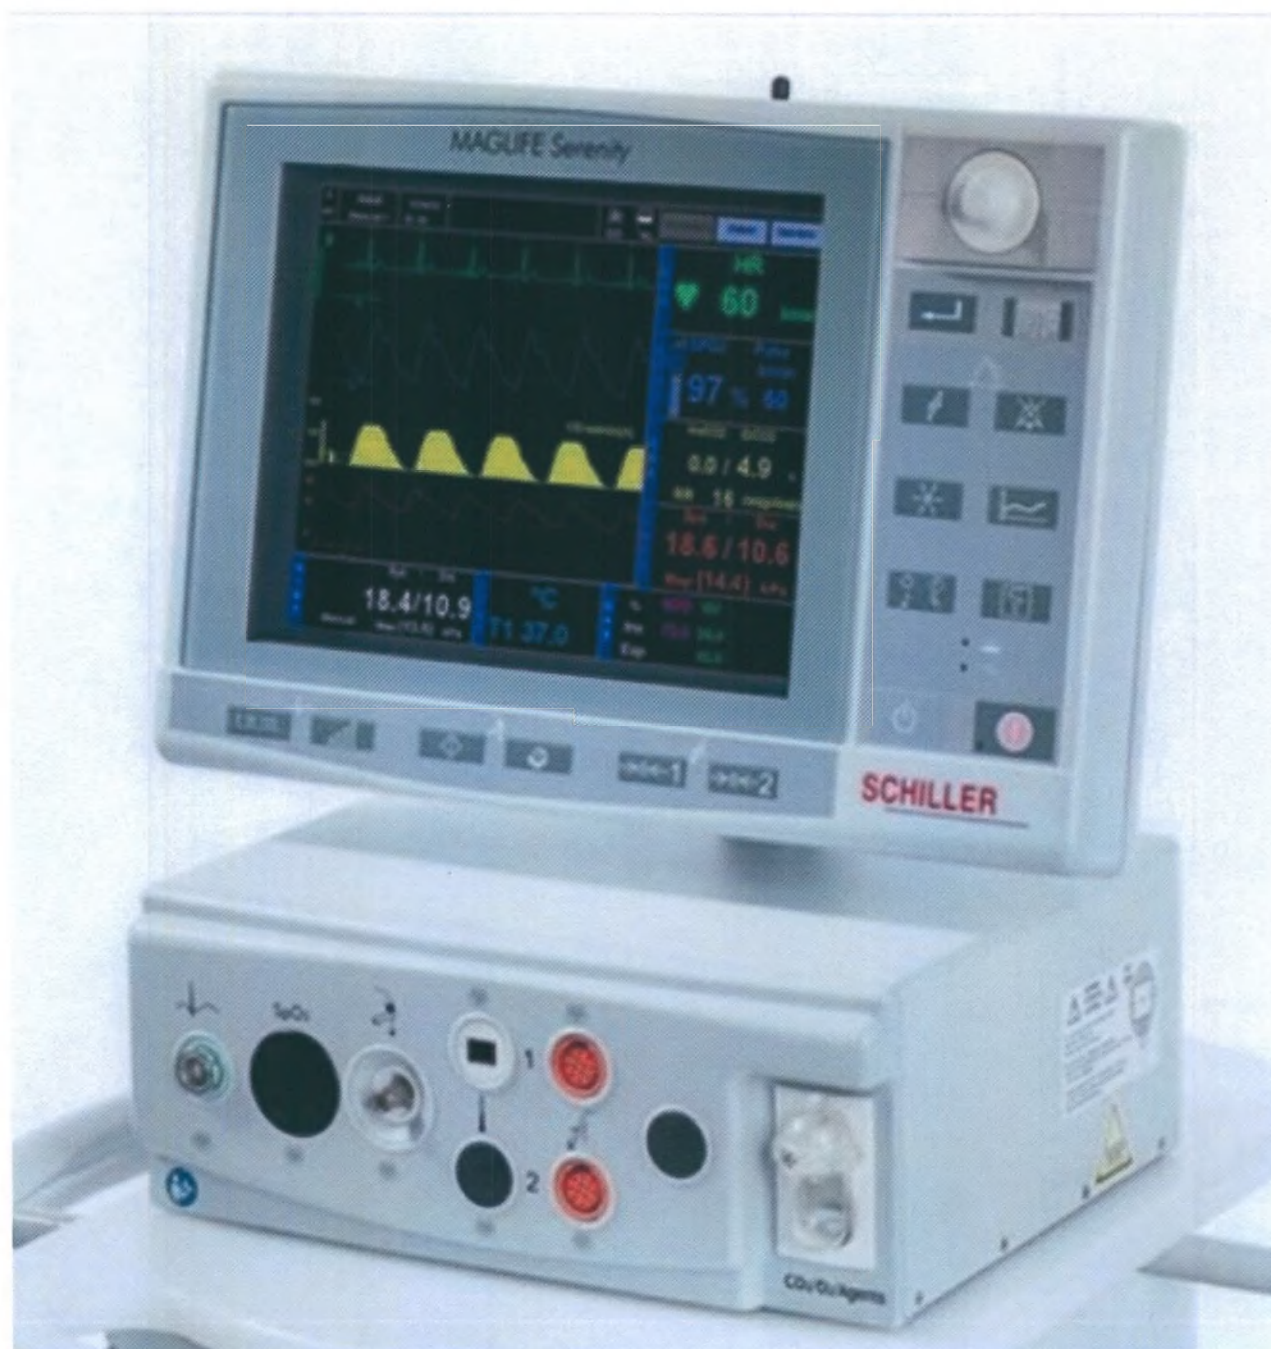

26. Немагнитный шкаф для хранения катушек

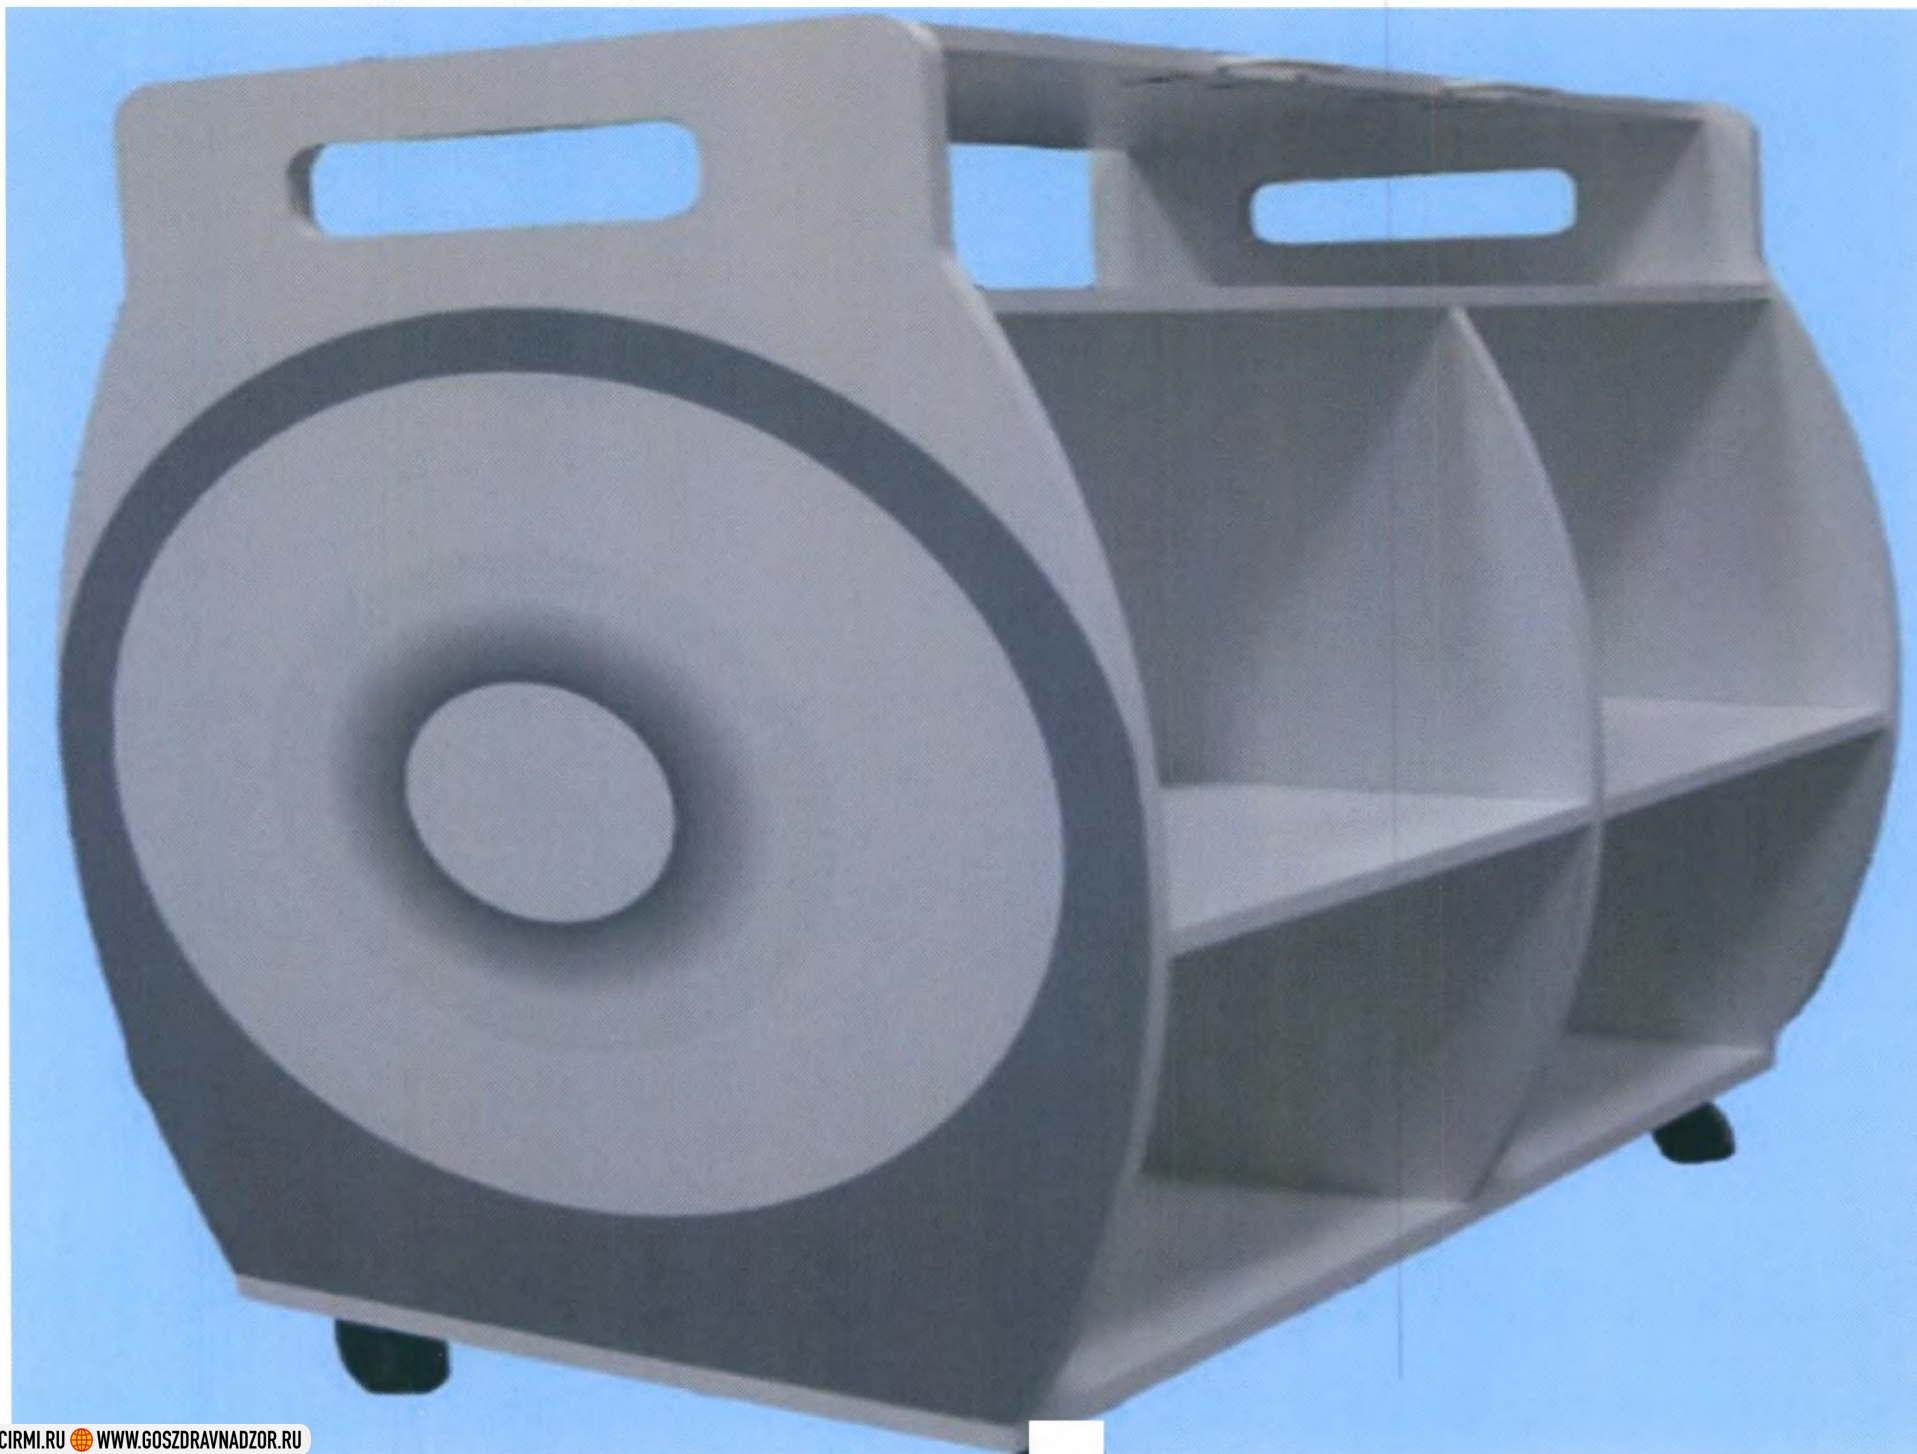

27. Охлаждающая жидкость



28. Портативный металлодетектор



29. Принтер медицинский




29. Принтер медицинский




30. Программное обеспечение и аппаратный компонент для получения данных эластографии








31. Программные обеспечения к системе МР томографа на оптических носителях или электронных носителях

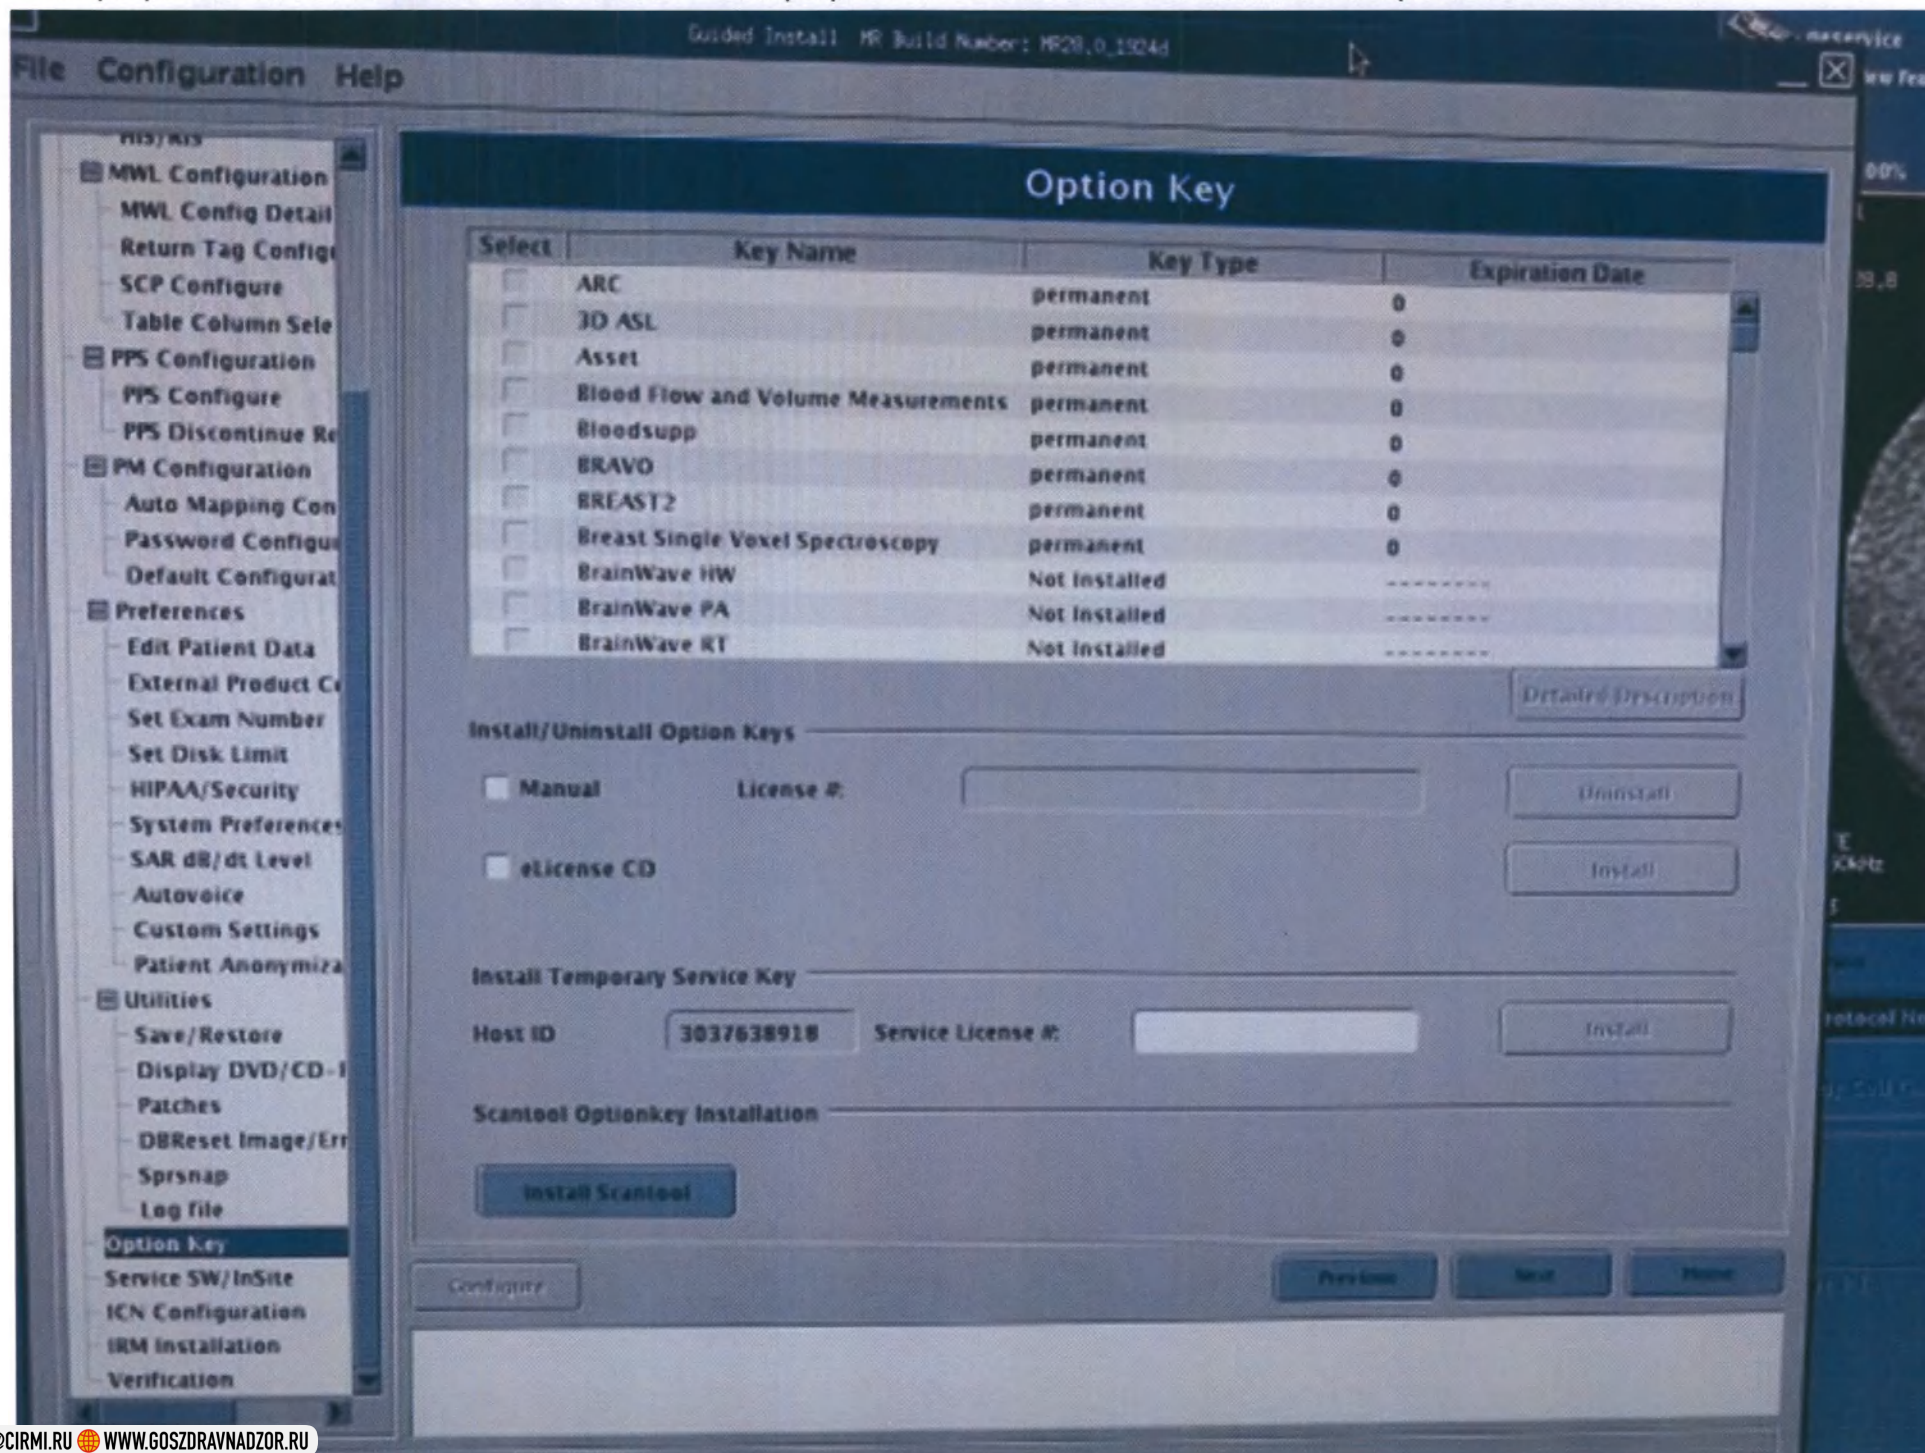







31. Программные обеспечения к системе МР томографа на оптических носителях или электронных носителях

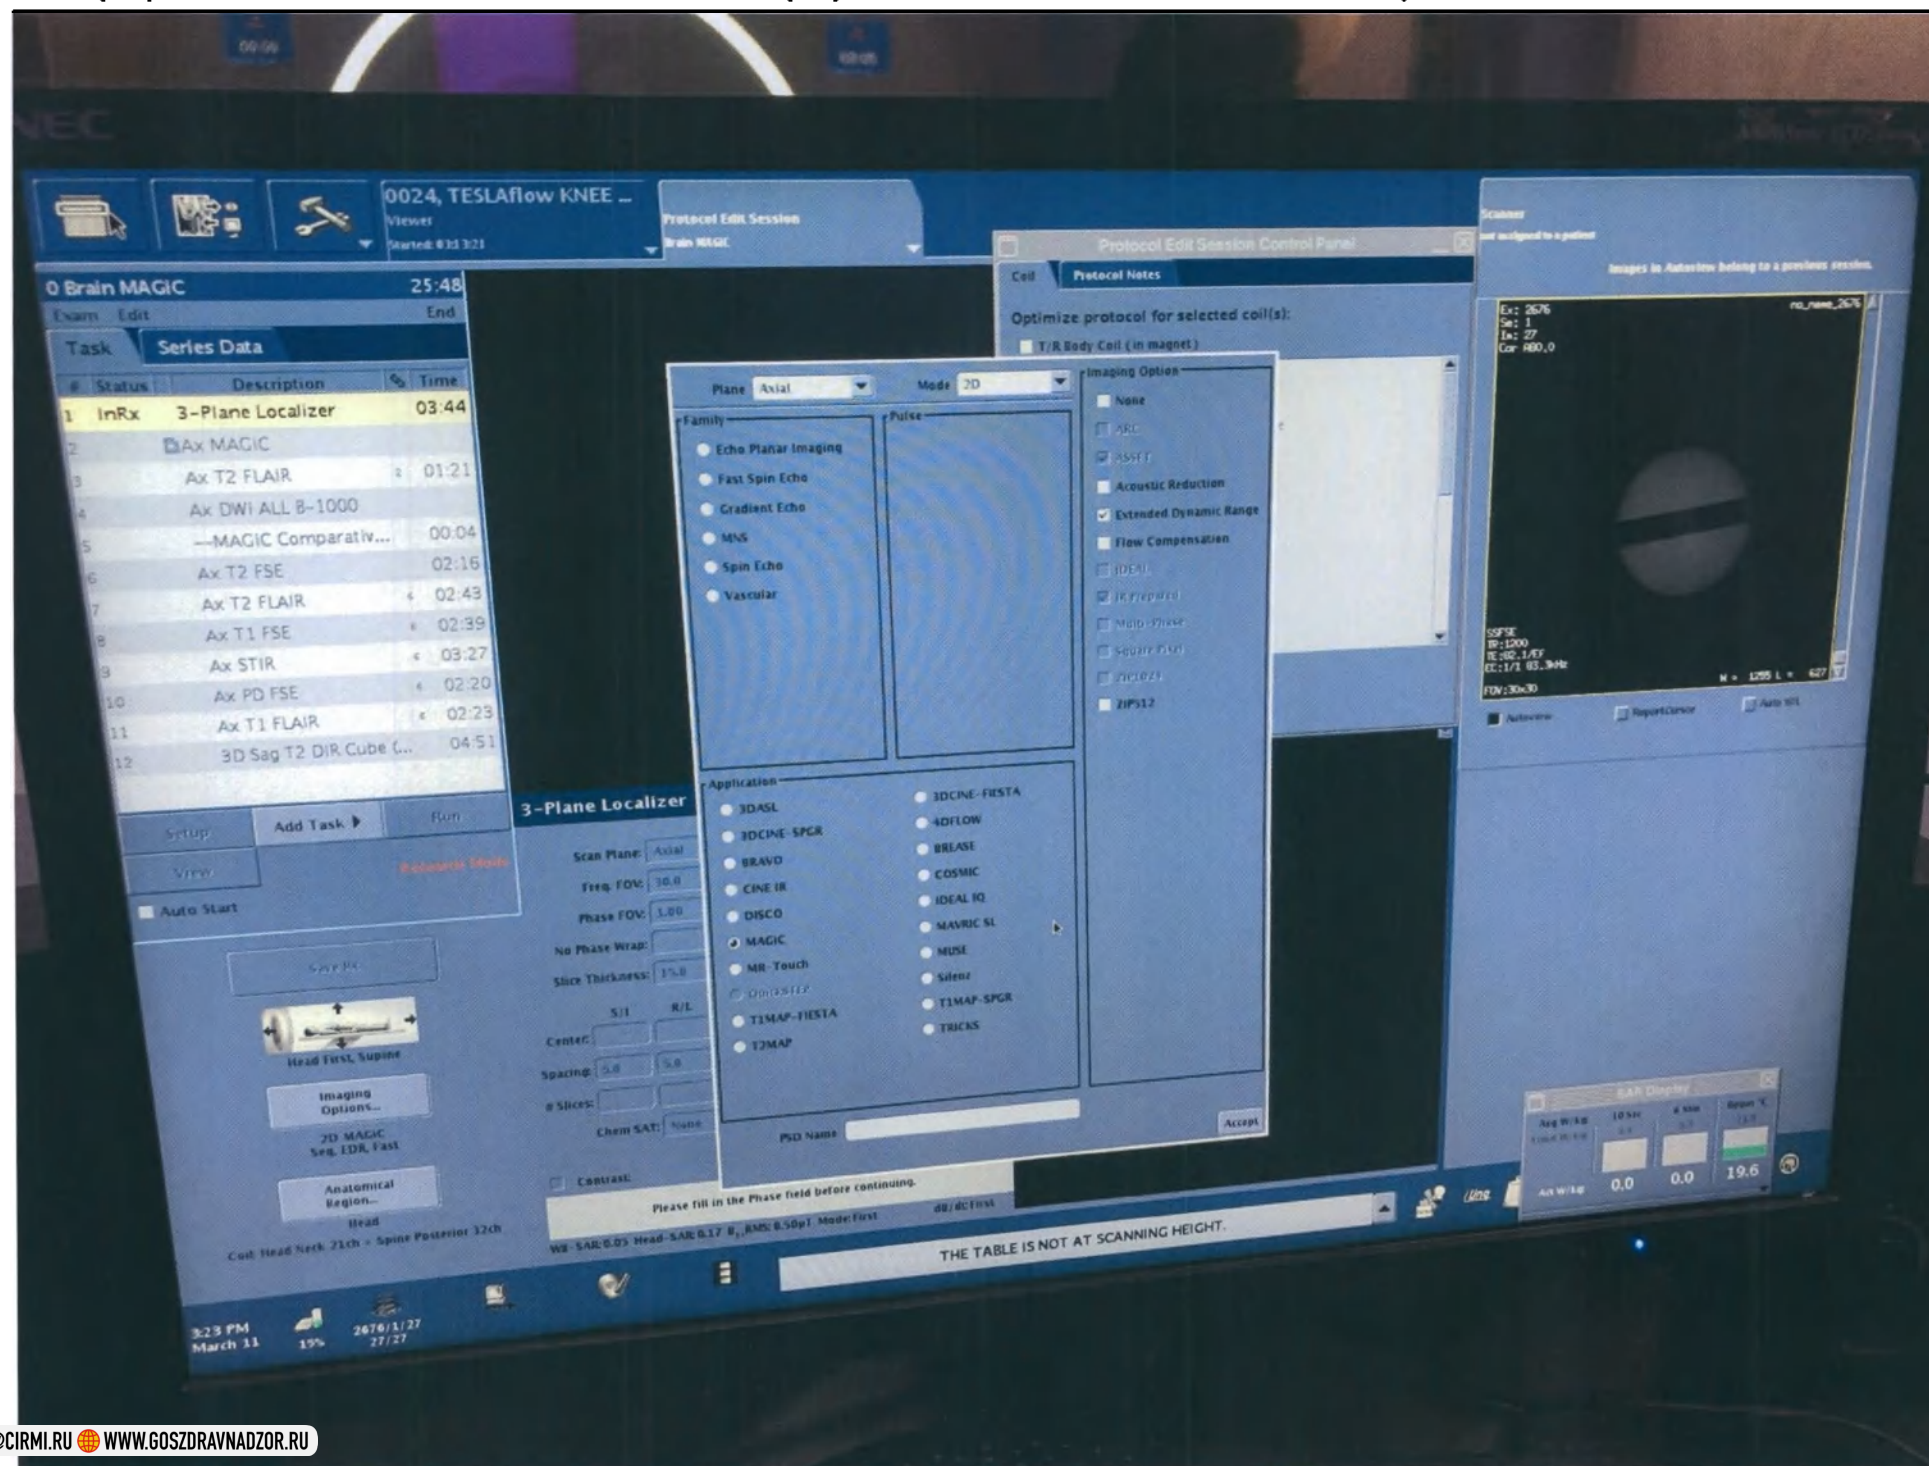


32. Программные приложения для научных исследований

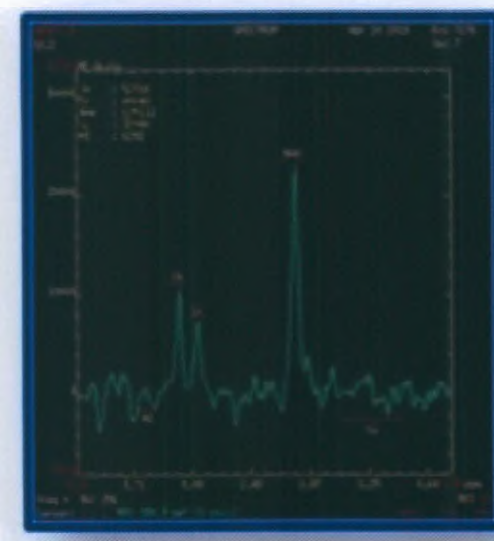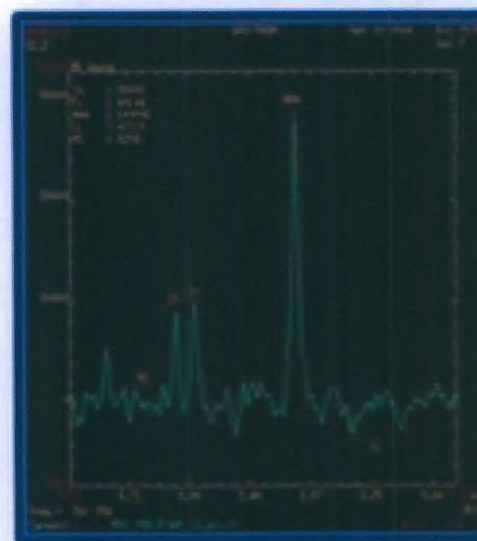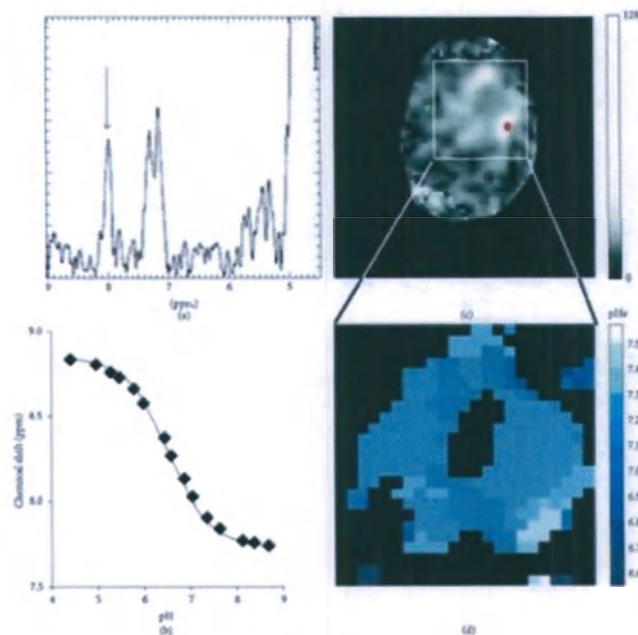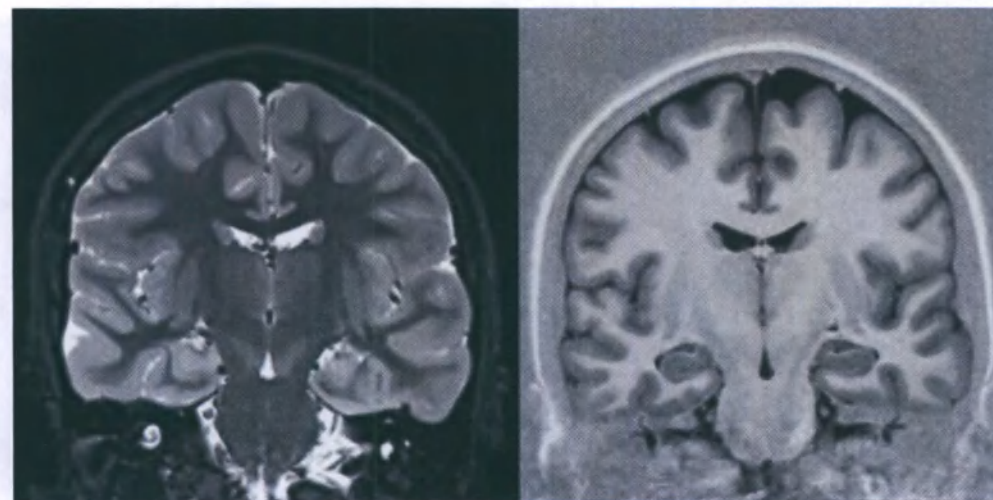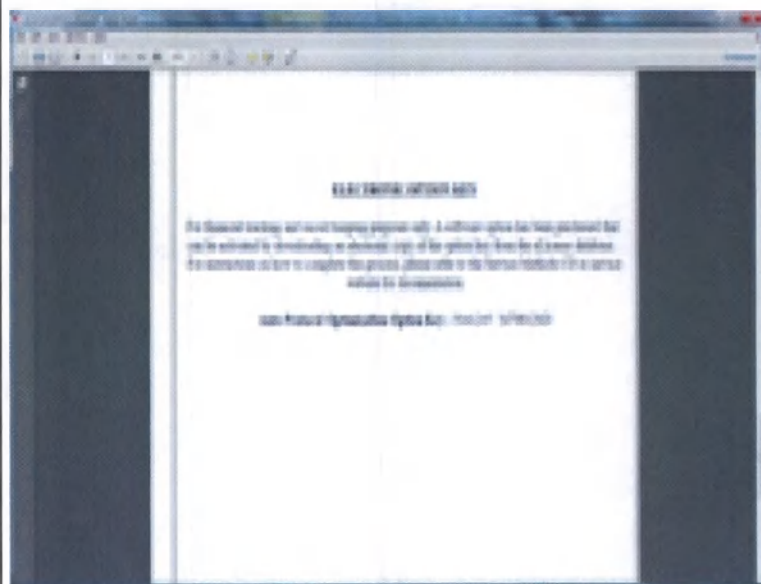

32. Программные приложения для научных исследований

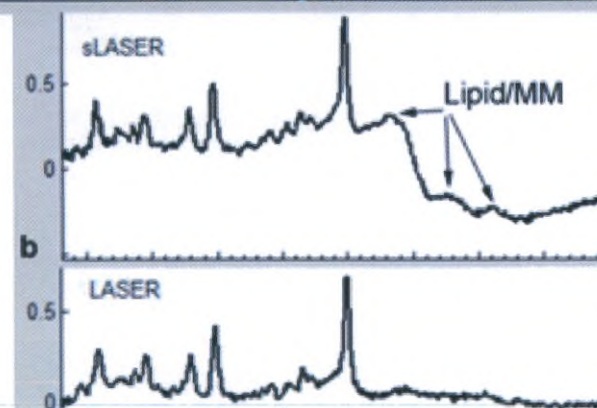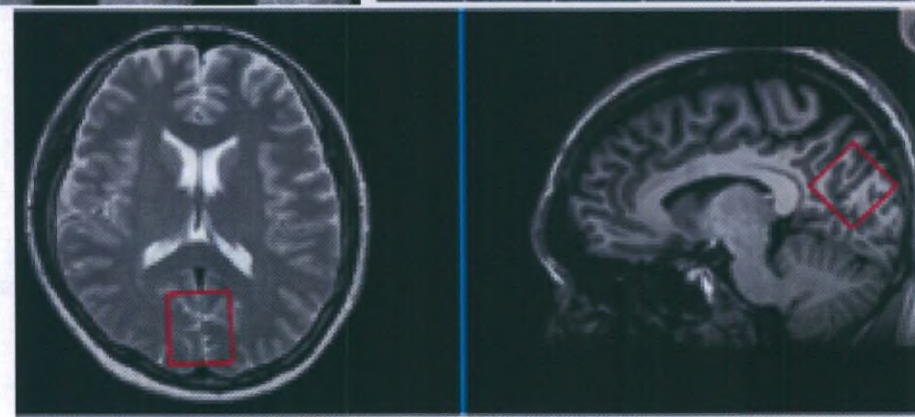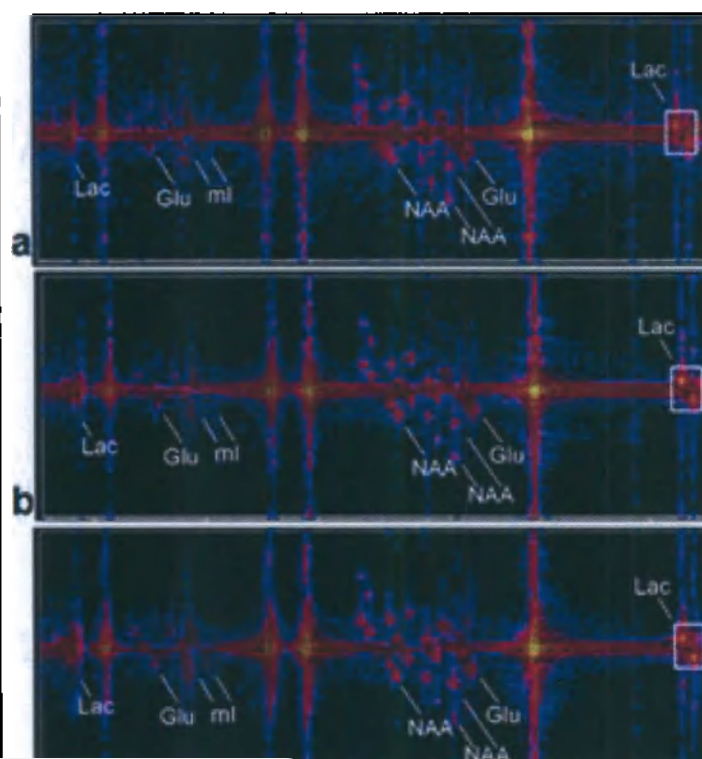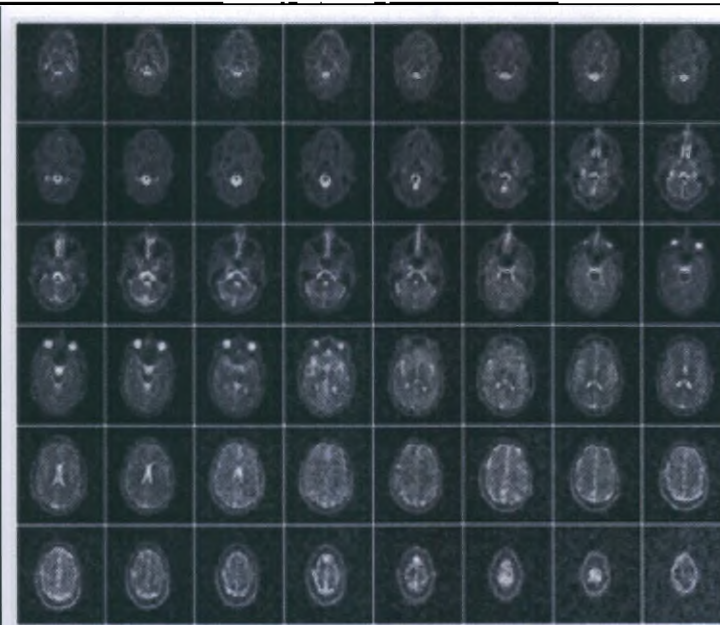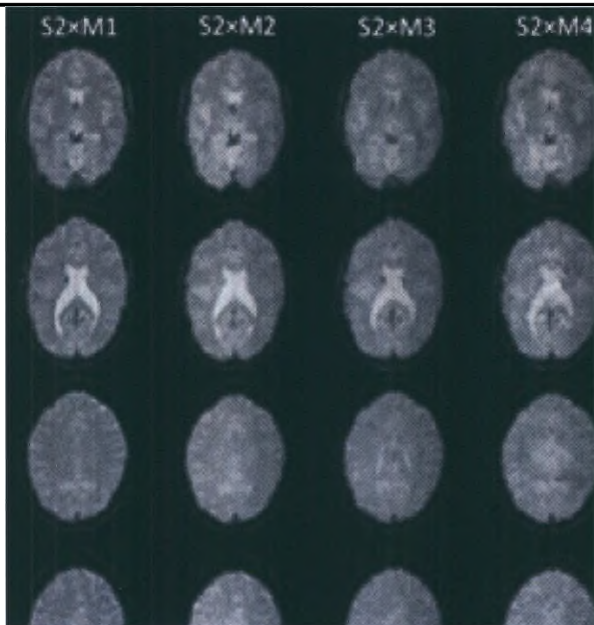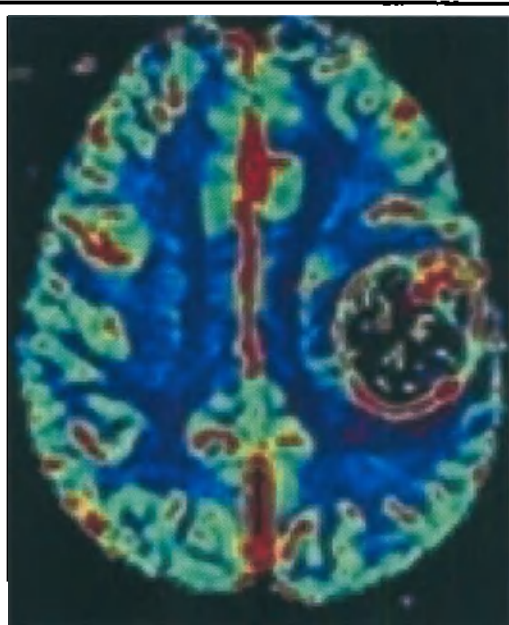


33. Сервисные и монтажные инструменты

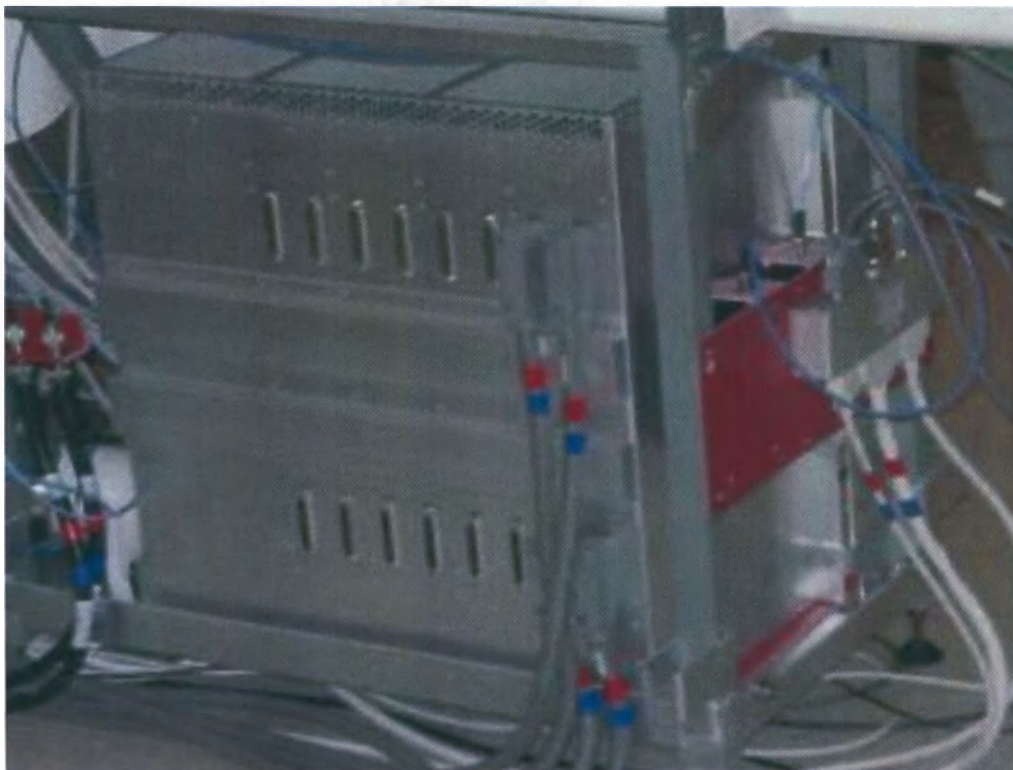

33. Сервисные и монтажные инструменты




33. Сервисные и монтажные инструменты

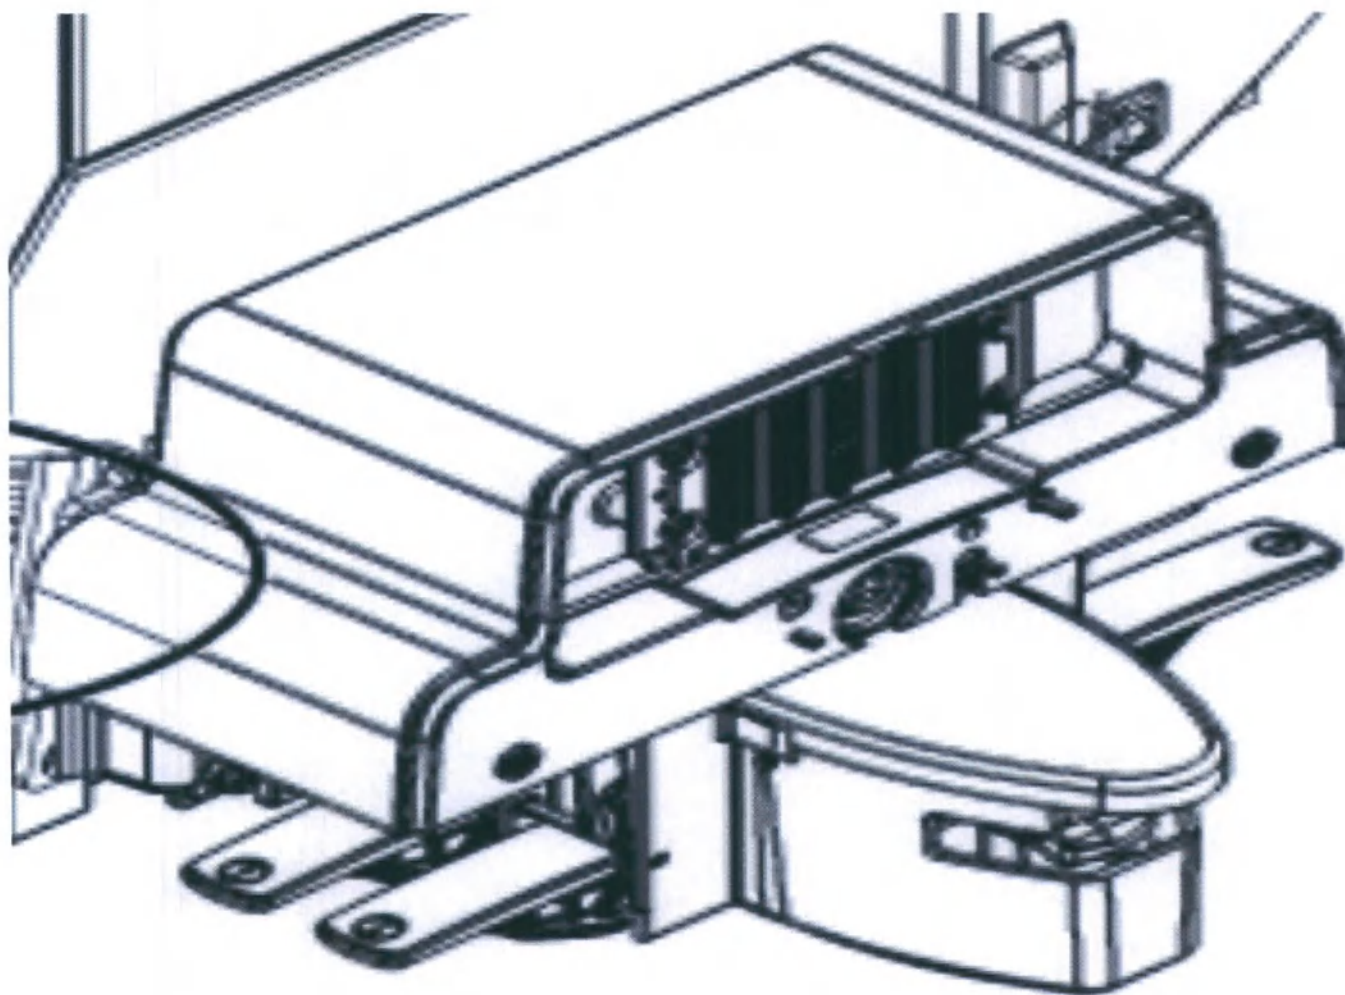


33. Сервисные и монтажные инструменты



33. Сервисные и монтажные инструменты

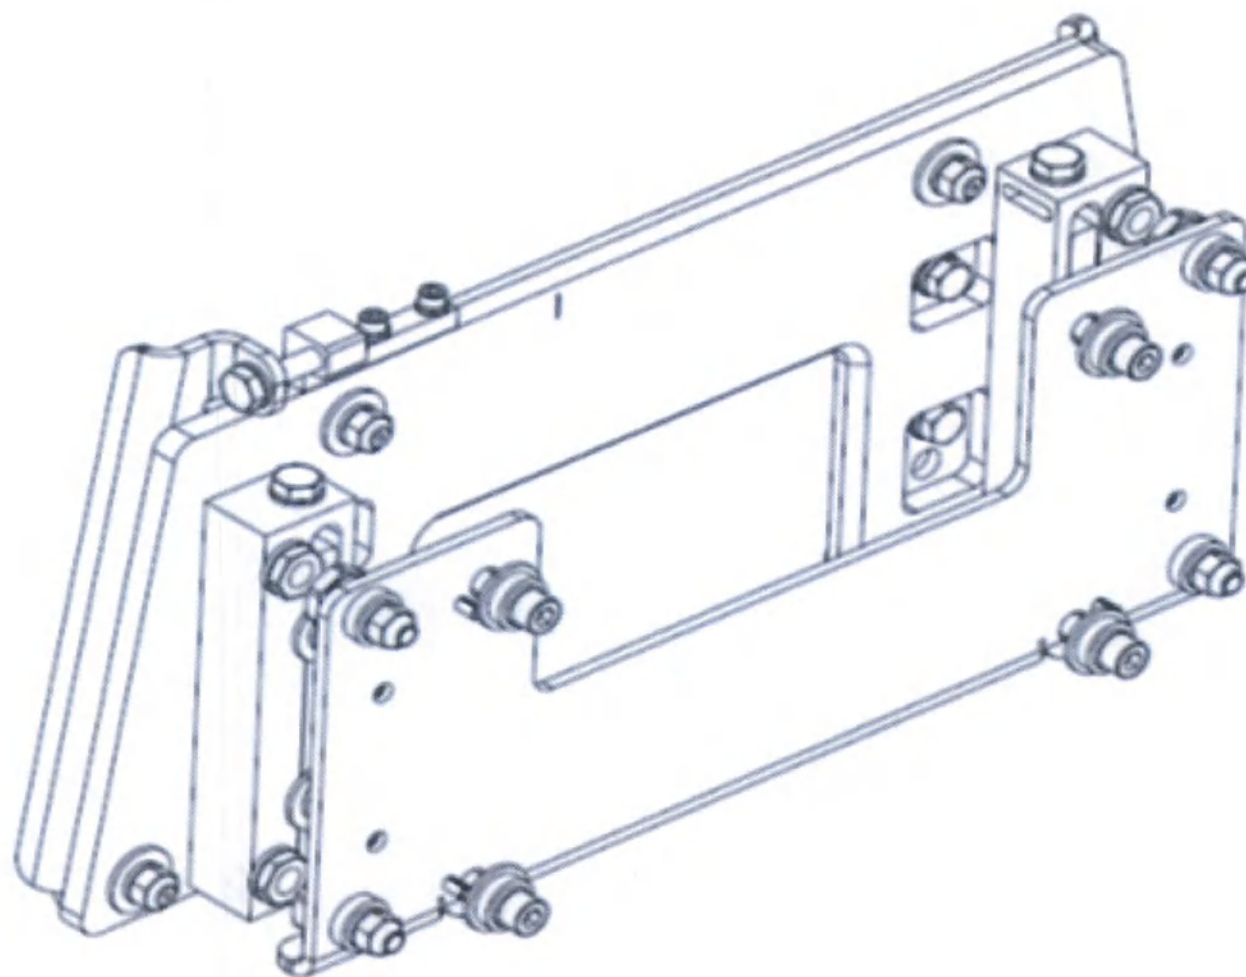


33. Сервисные и монтажные инструменты

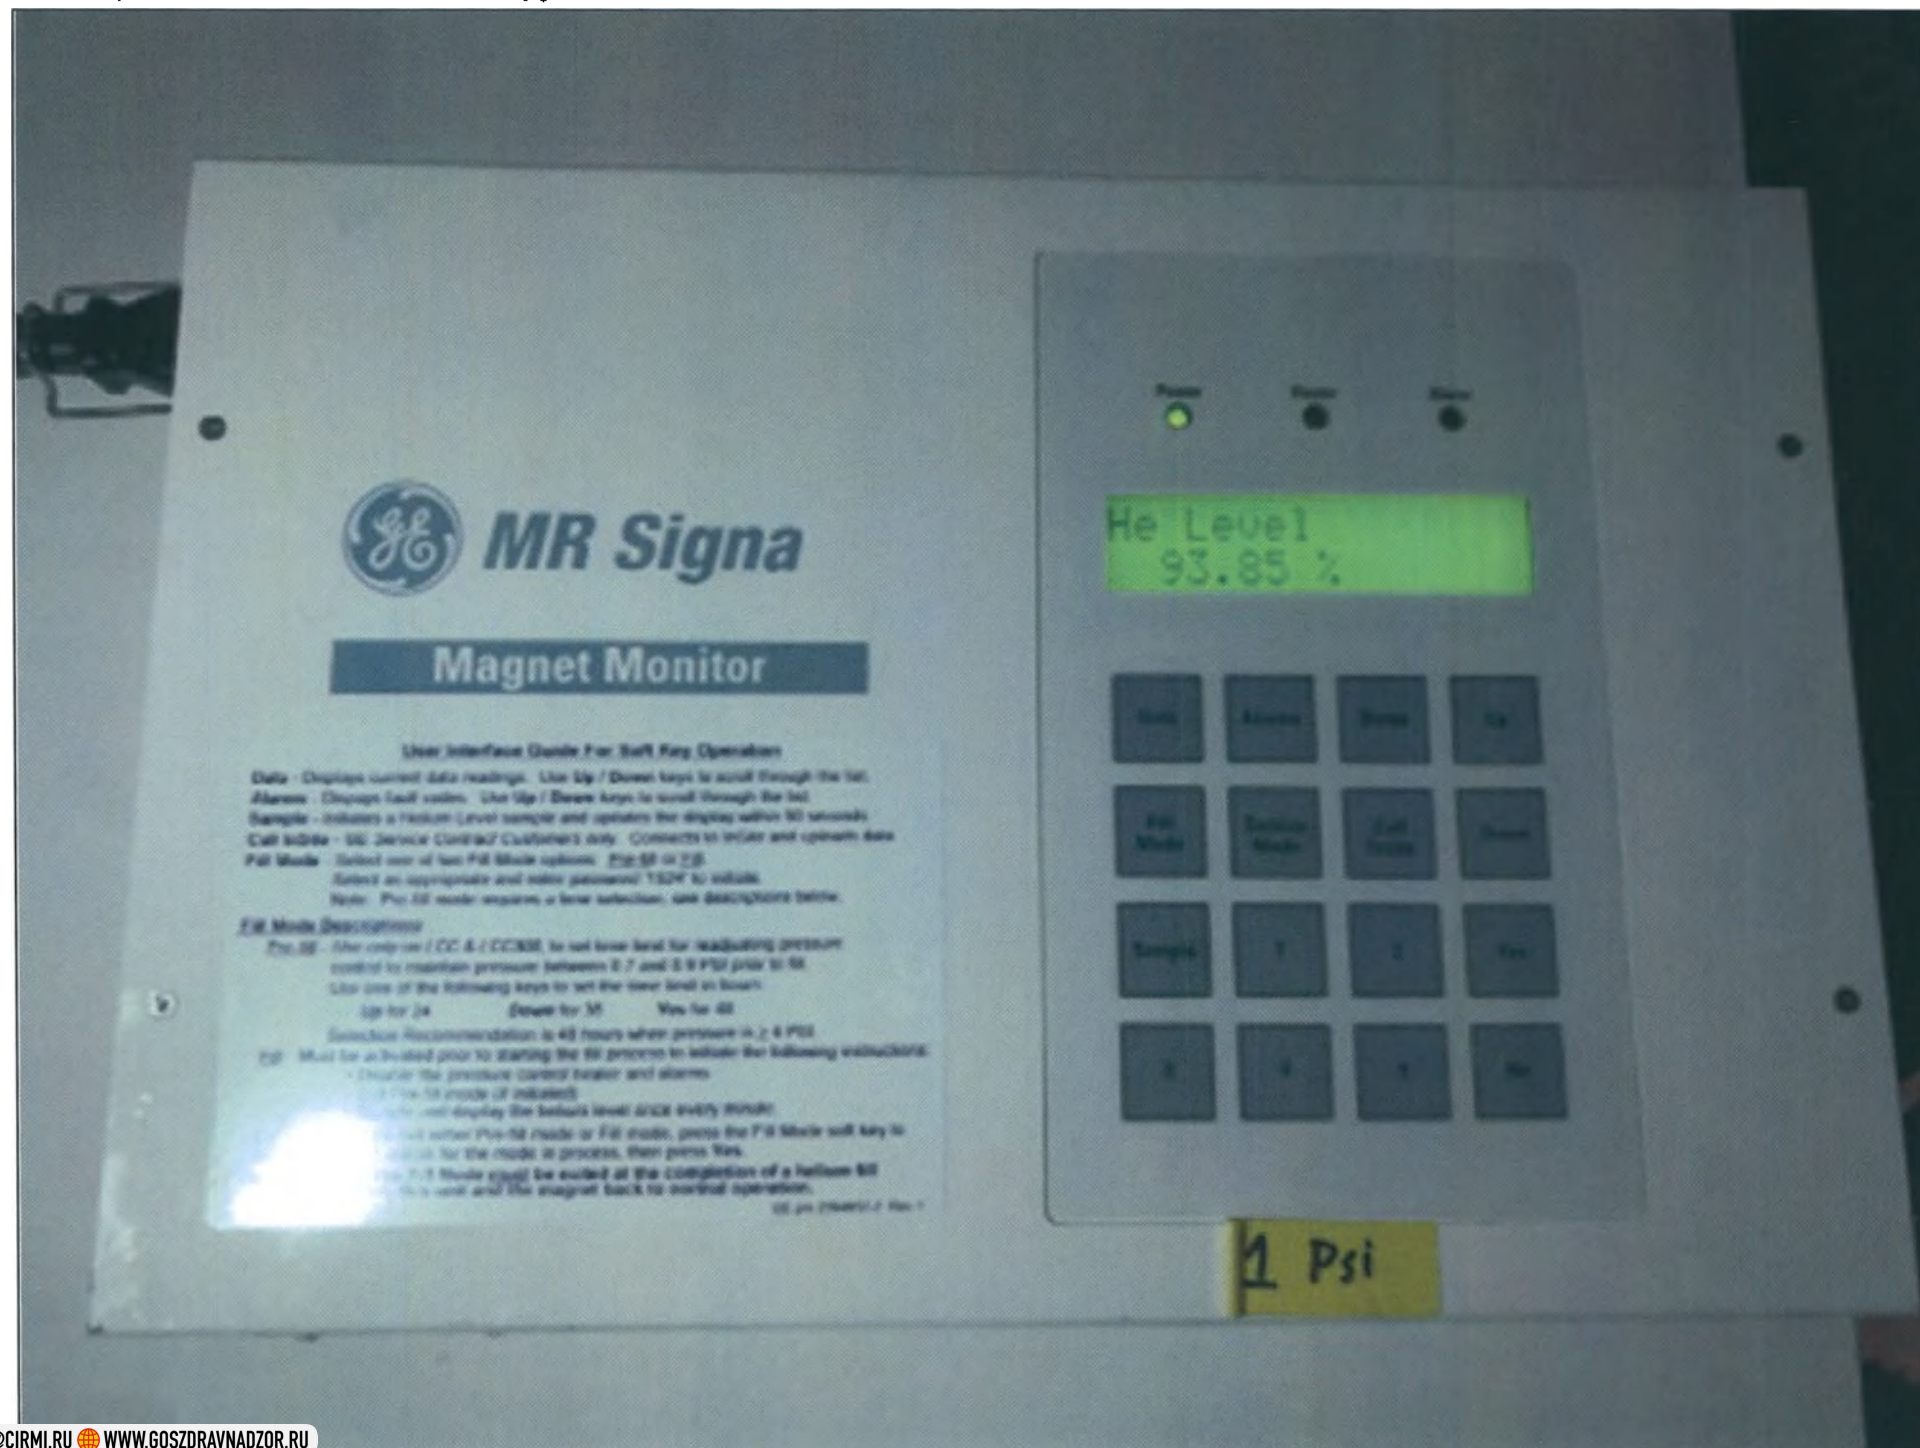



34. Стен оператора

34. Стол оператора

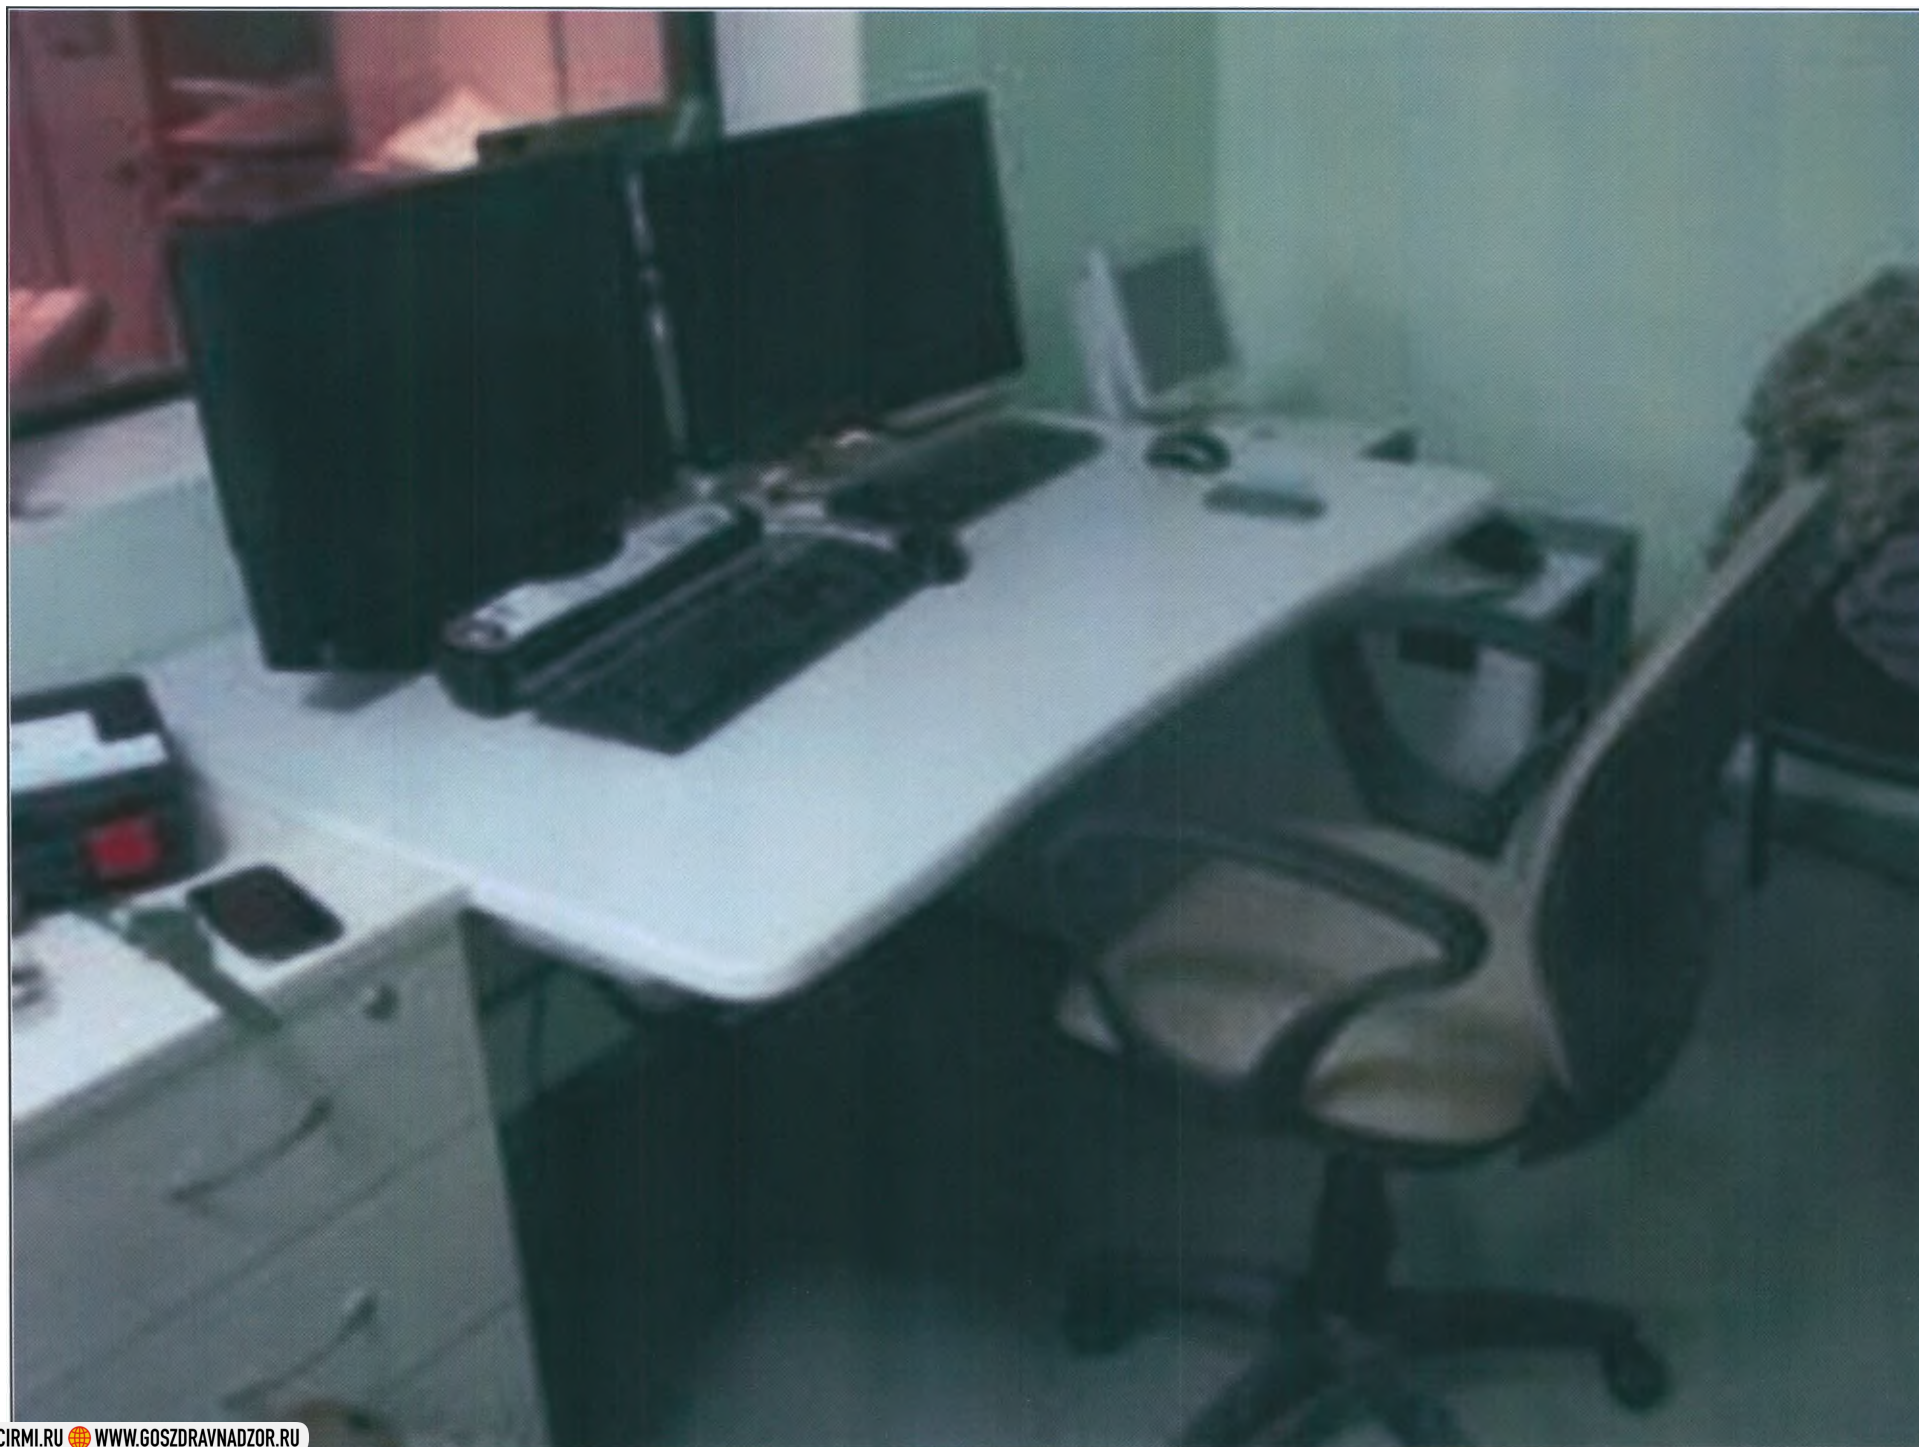

35. Стул оператора



36. Тележки специальные для хранения фантомов



37. Немагнитная каталка пациента



37. Немагнитная каталка пациента





38. Термобумага




38. Термобумага



39. Устройства для позиционирования и подключения катушек



39. Устройства для позиционирования и подключения катушек

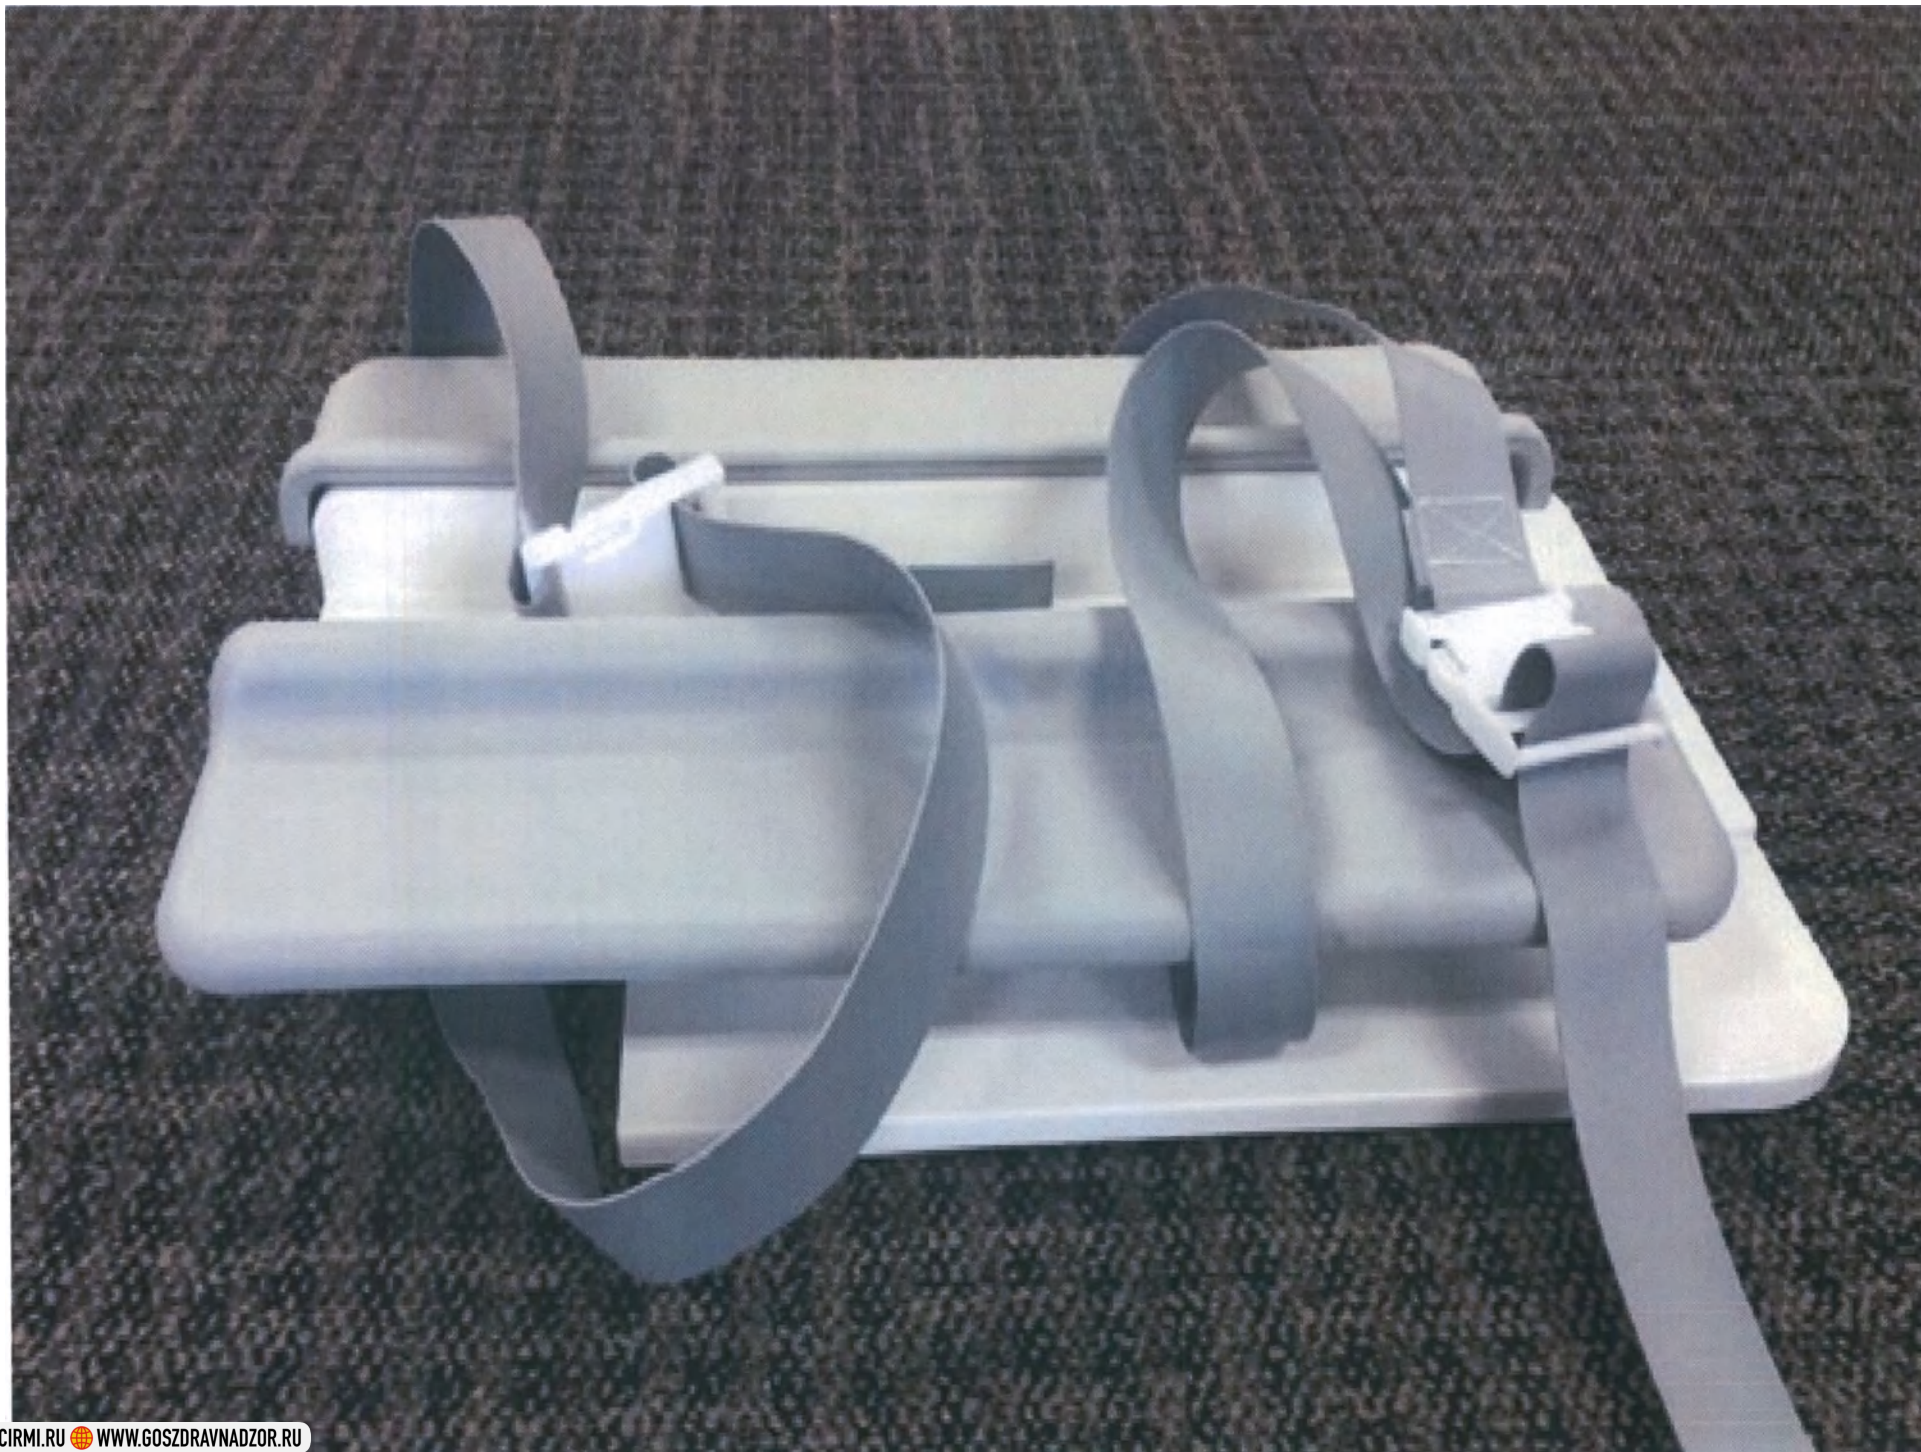

39. Устройства для позиционирования и подключения катушек




39. Устройства для позиционирования и подключения катушек



39. Устройства для позиционирования и подключения катушек



39. Устройства для позиционирования и подключения катушек

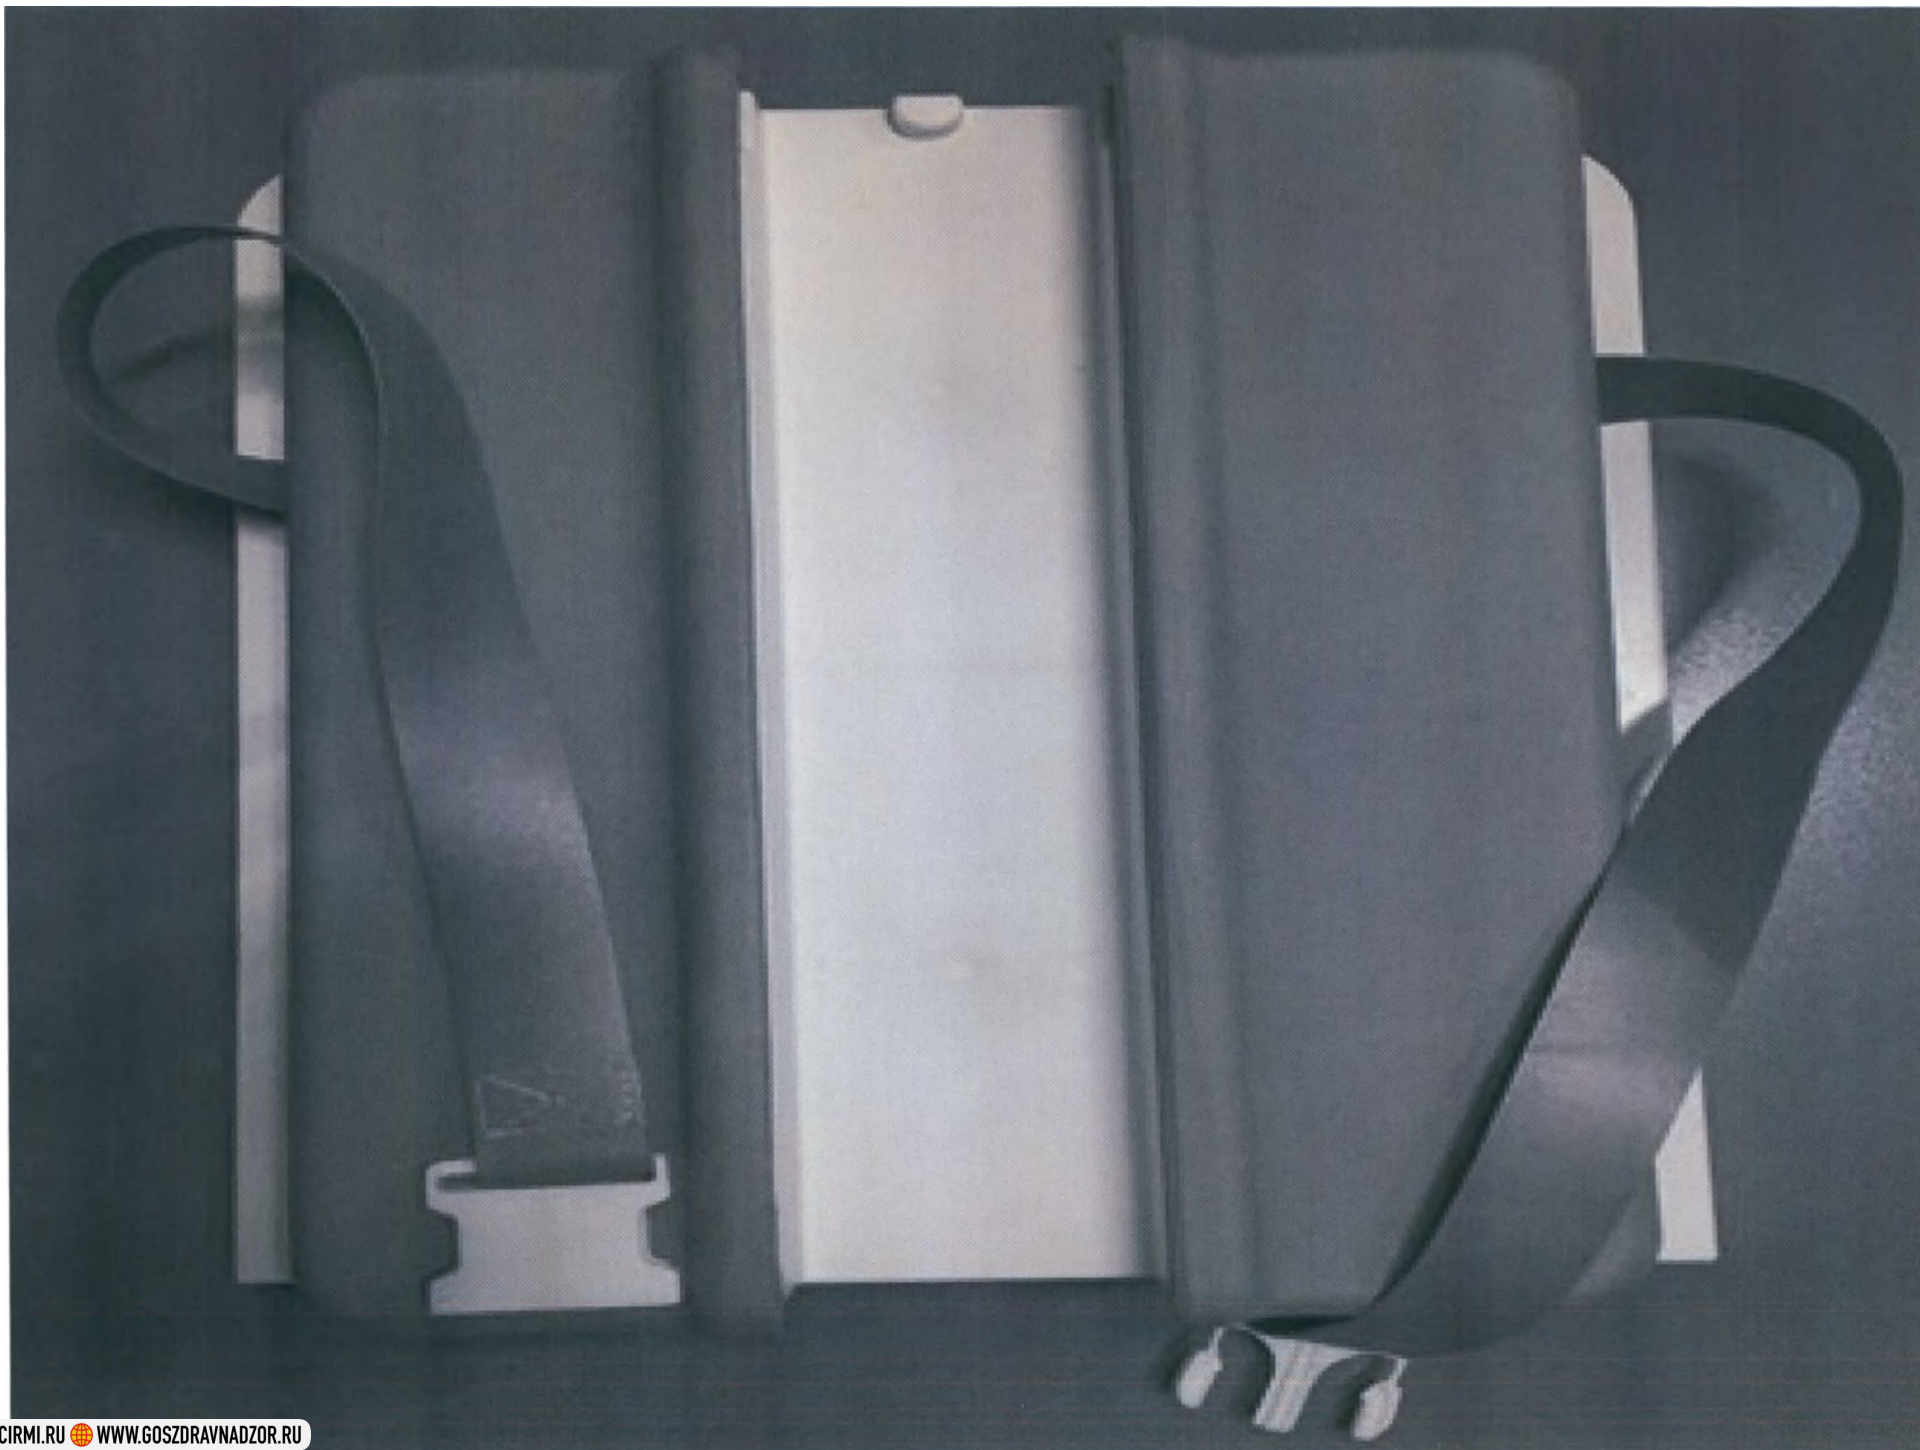


39. Устройства для позиционирования и подключения катушек



39. Устройства для позиционирования и подключения катушек



39. Устройства для позиционирования и подключения катушек

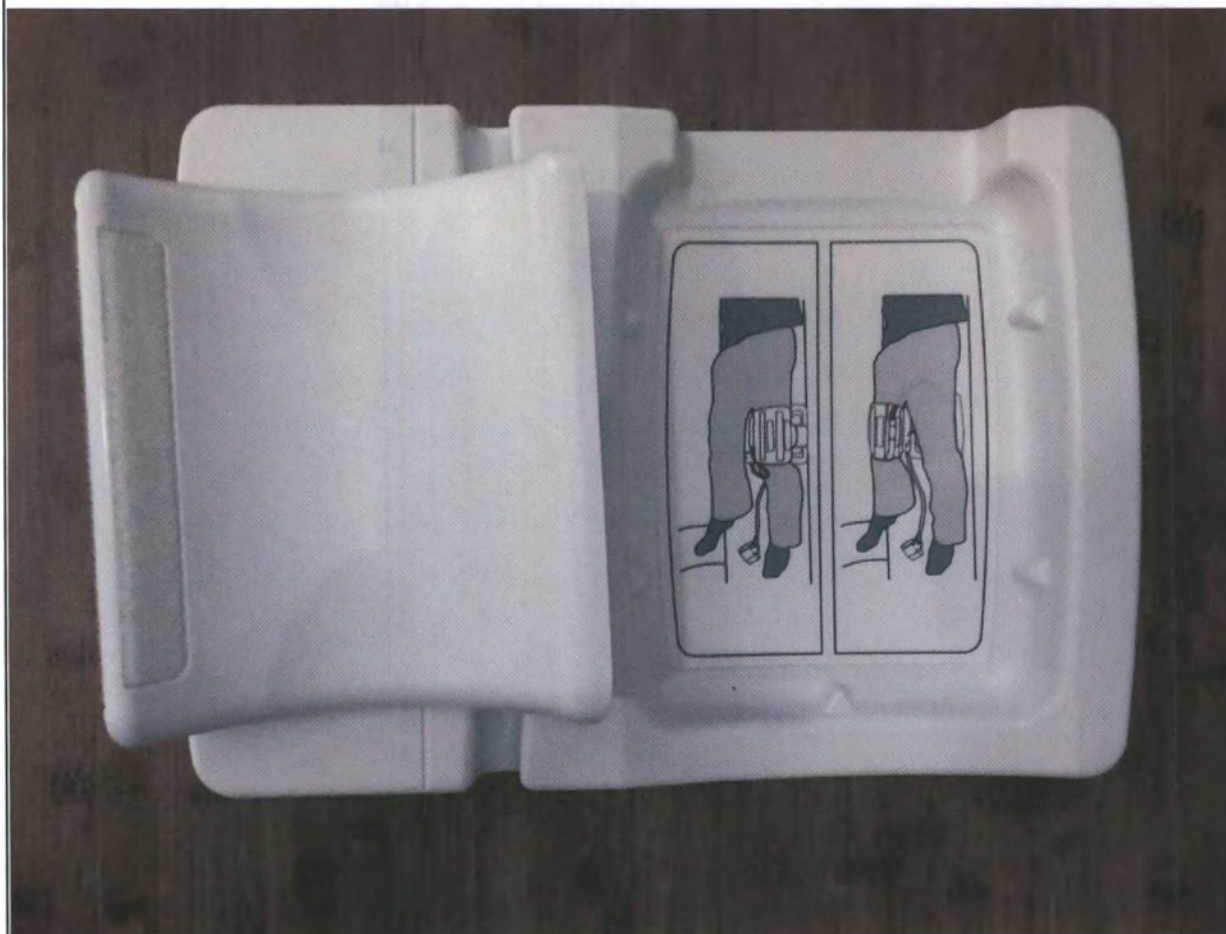

39. Устройства для позиционирования и подключения катушек



39. Устройства для позиционирования и подключения катушек



39. Устройства для позиционирования и подключения катушек



39. Устройства для позиционирования и подключения катушек



39. Устройства для позиционирования и подключения катушек




39. Устройства для позиционирования и подключения катушек



39. Устройства для позиционирования и подключения катушек



39. Устройства для позиционирования и подключения катушек

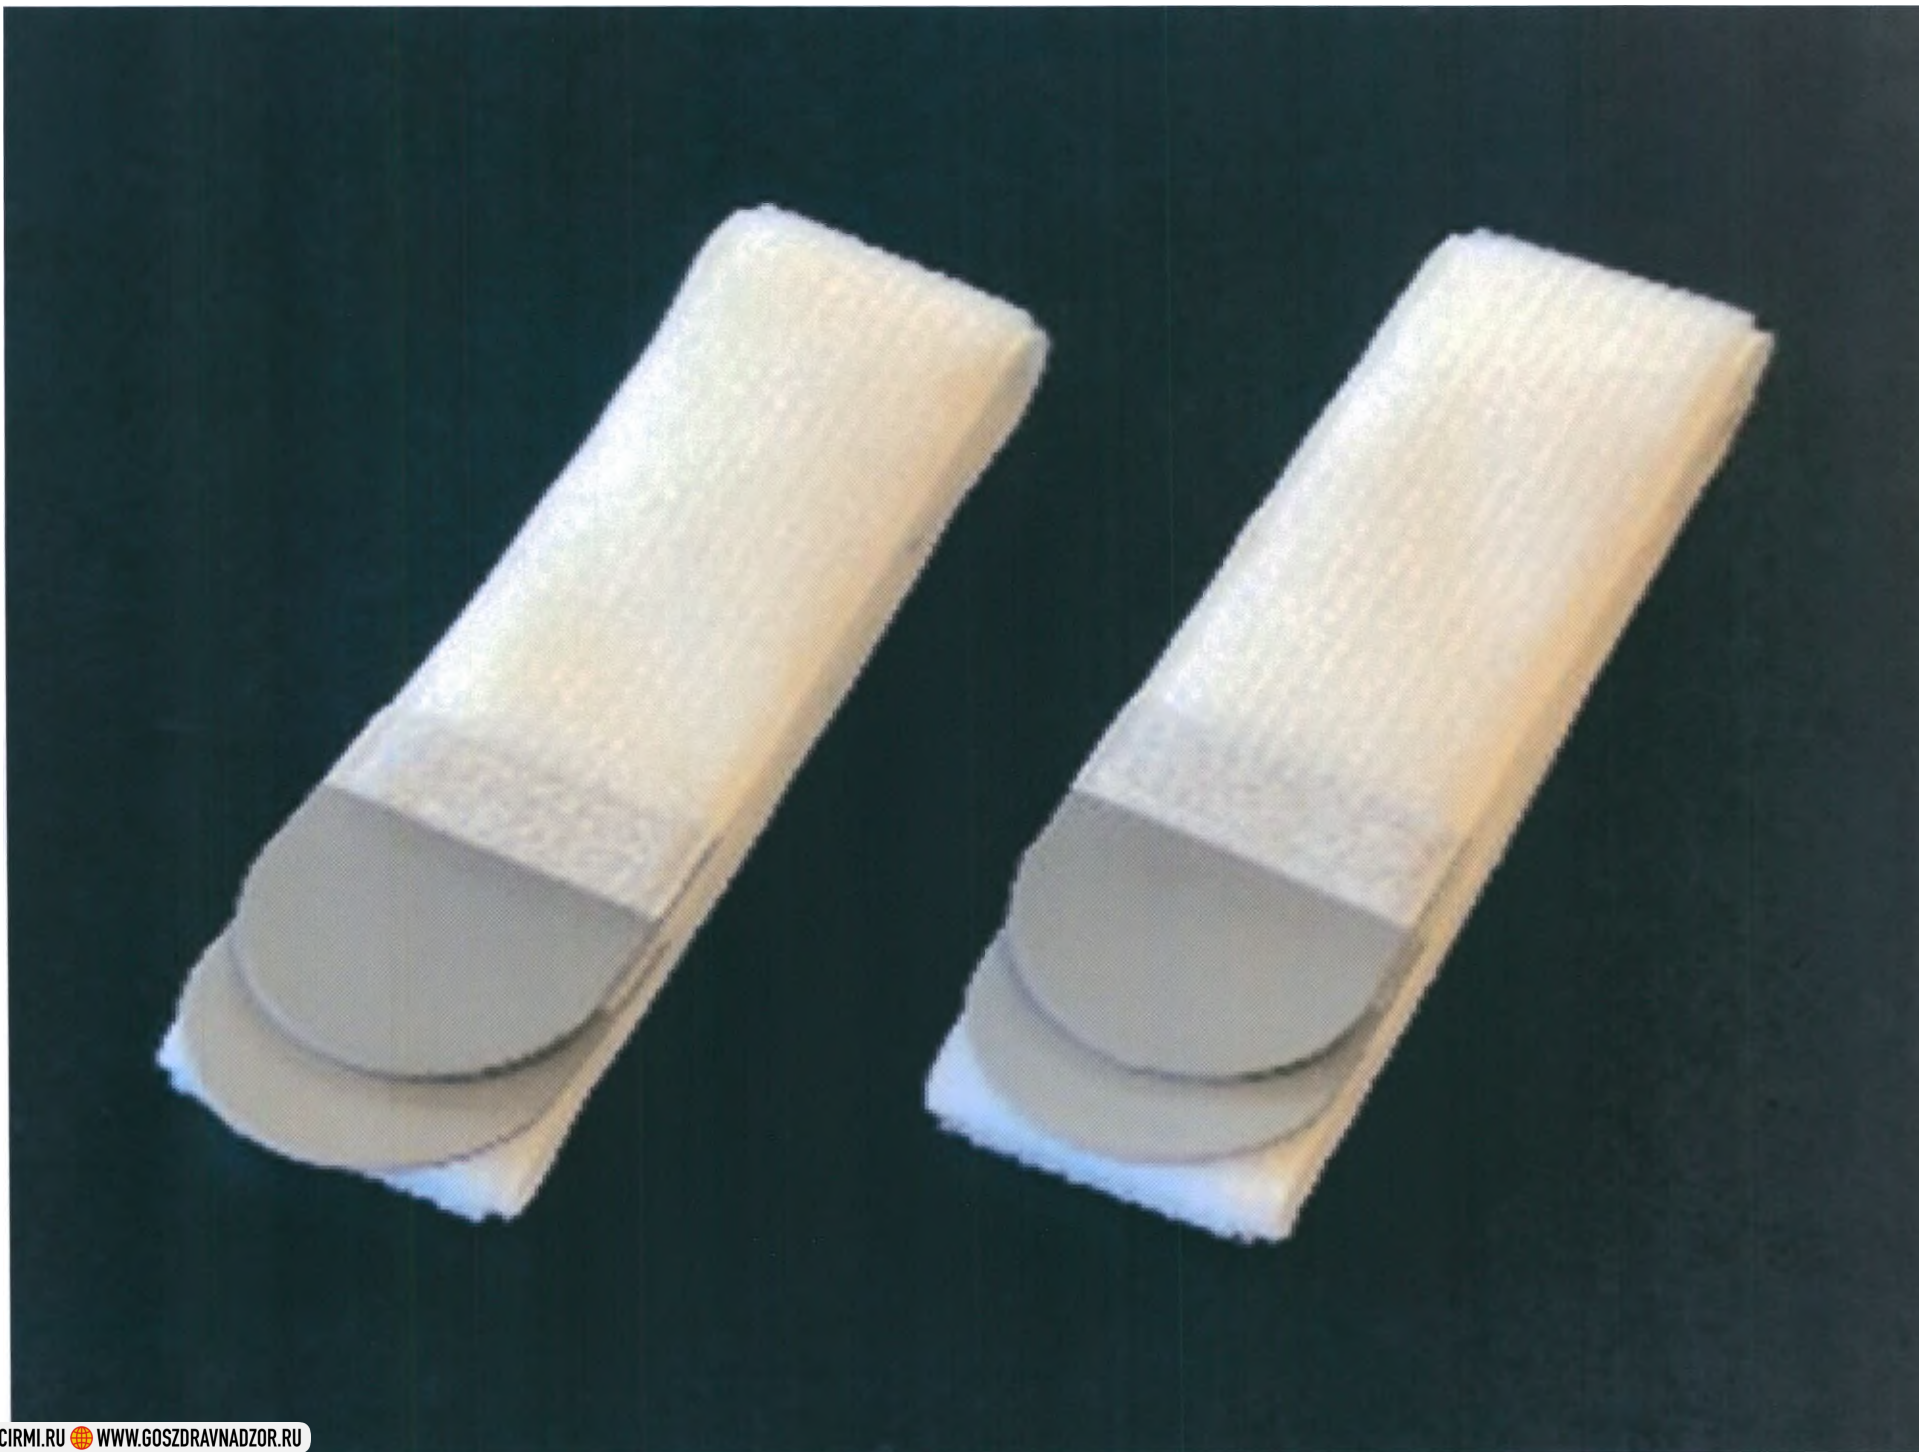


39. Устройства для позиционирования и подключения катушек




39. Устройства для позиционирования и подключения катушек



39. Устройства для позиционирования и подключения катушек

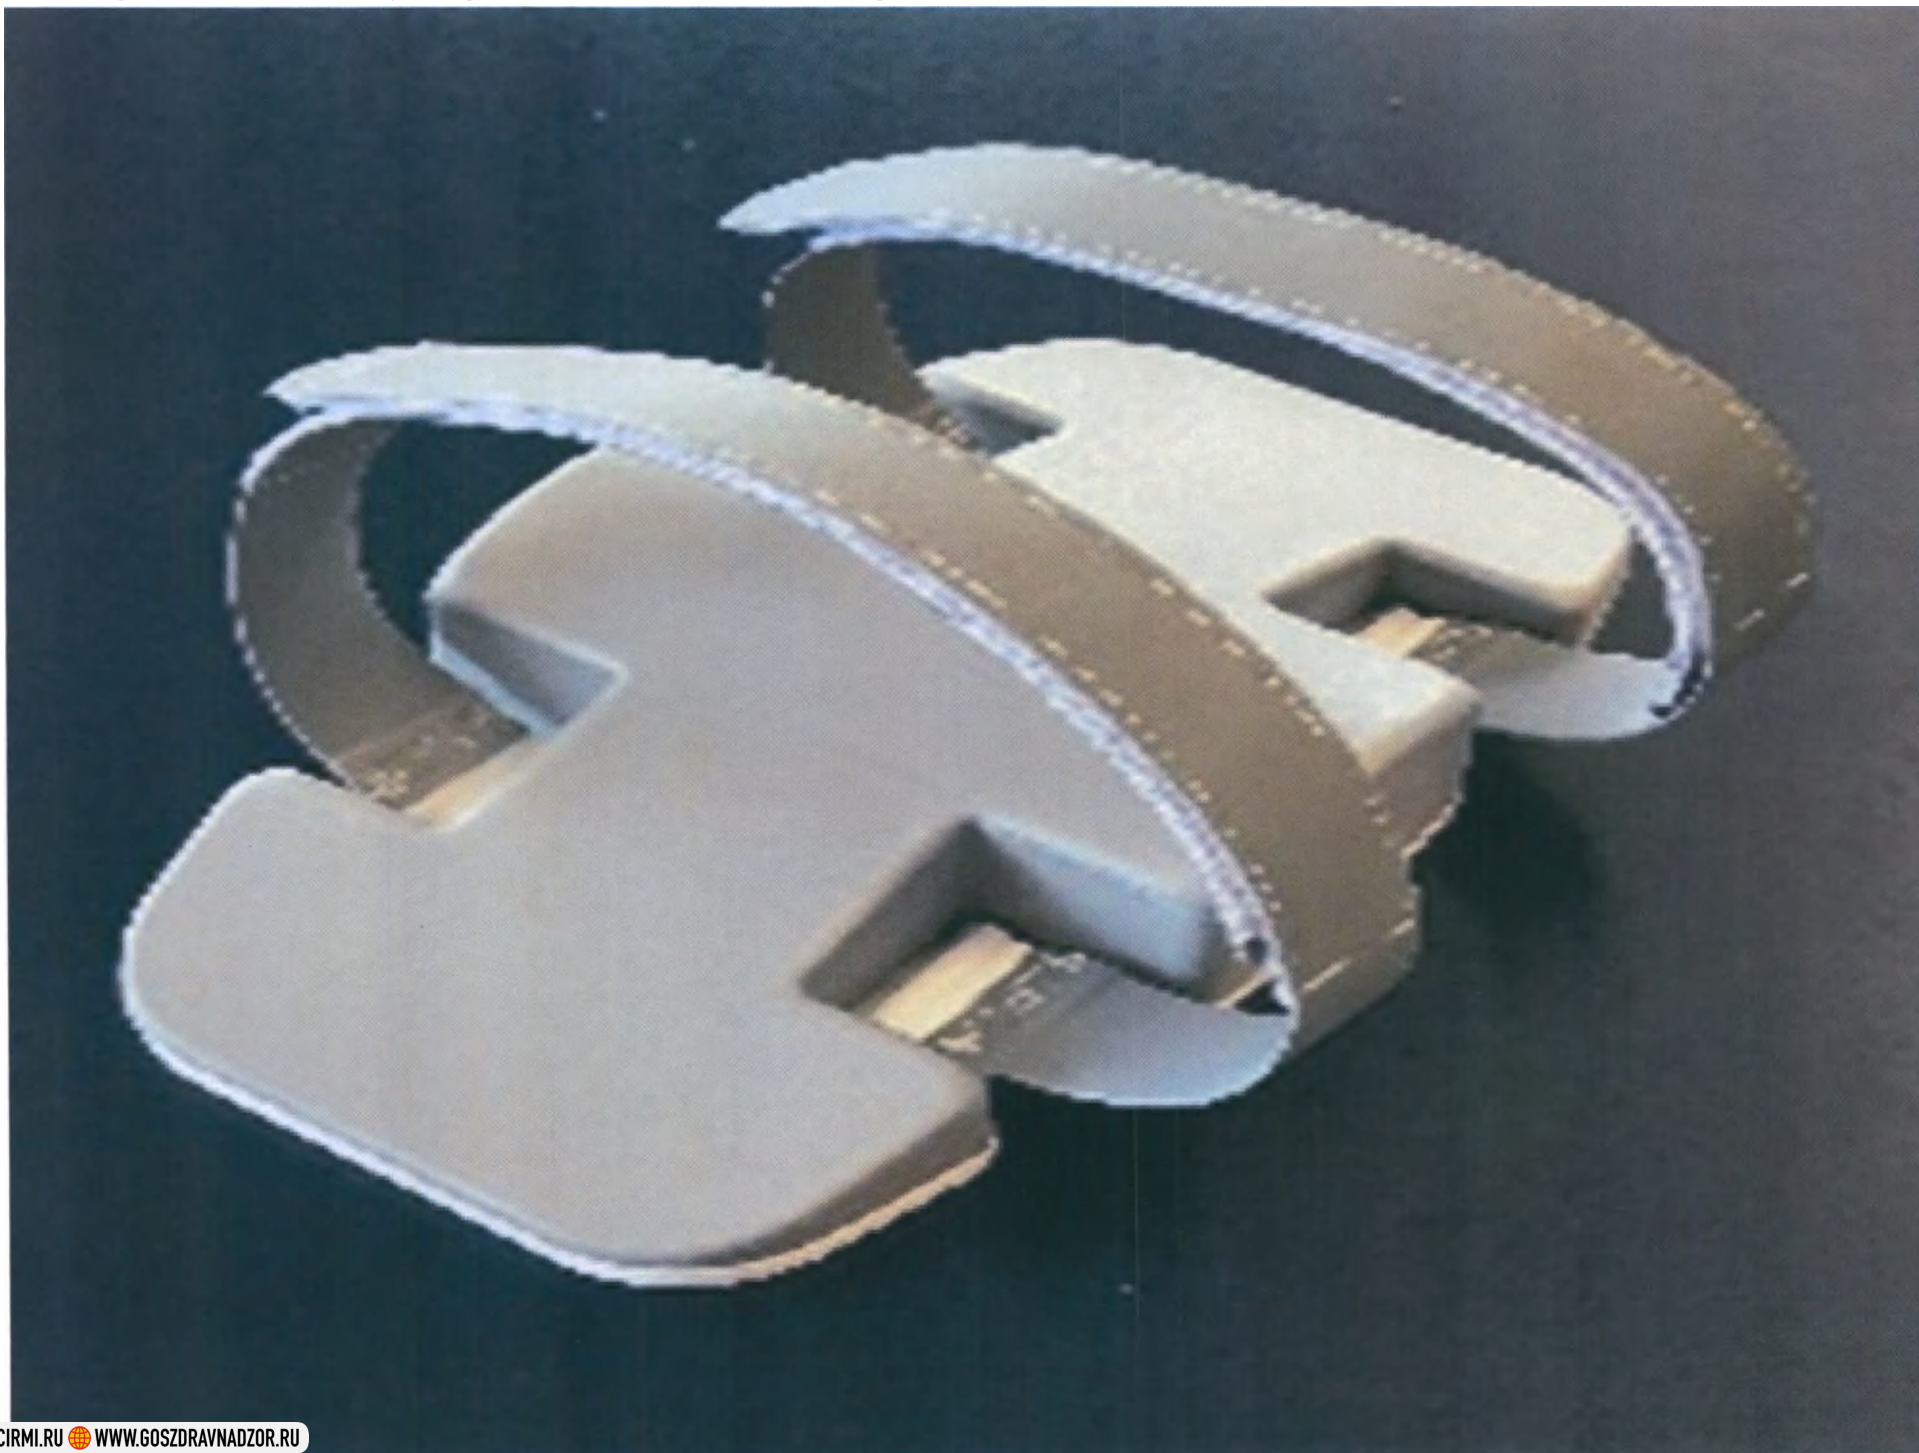

39. Устройства для позиционирования и подключения катушек

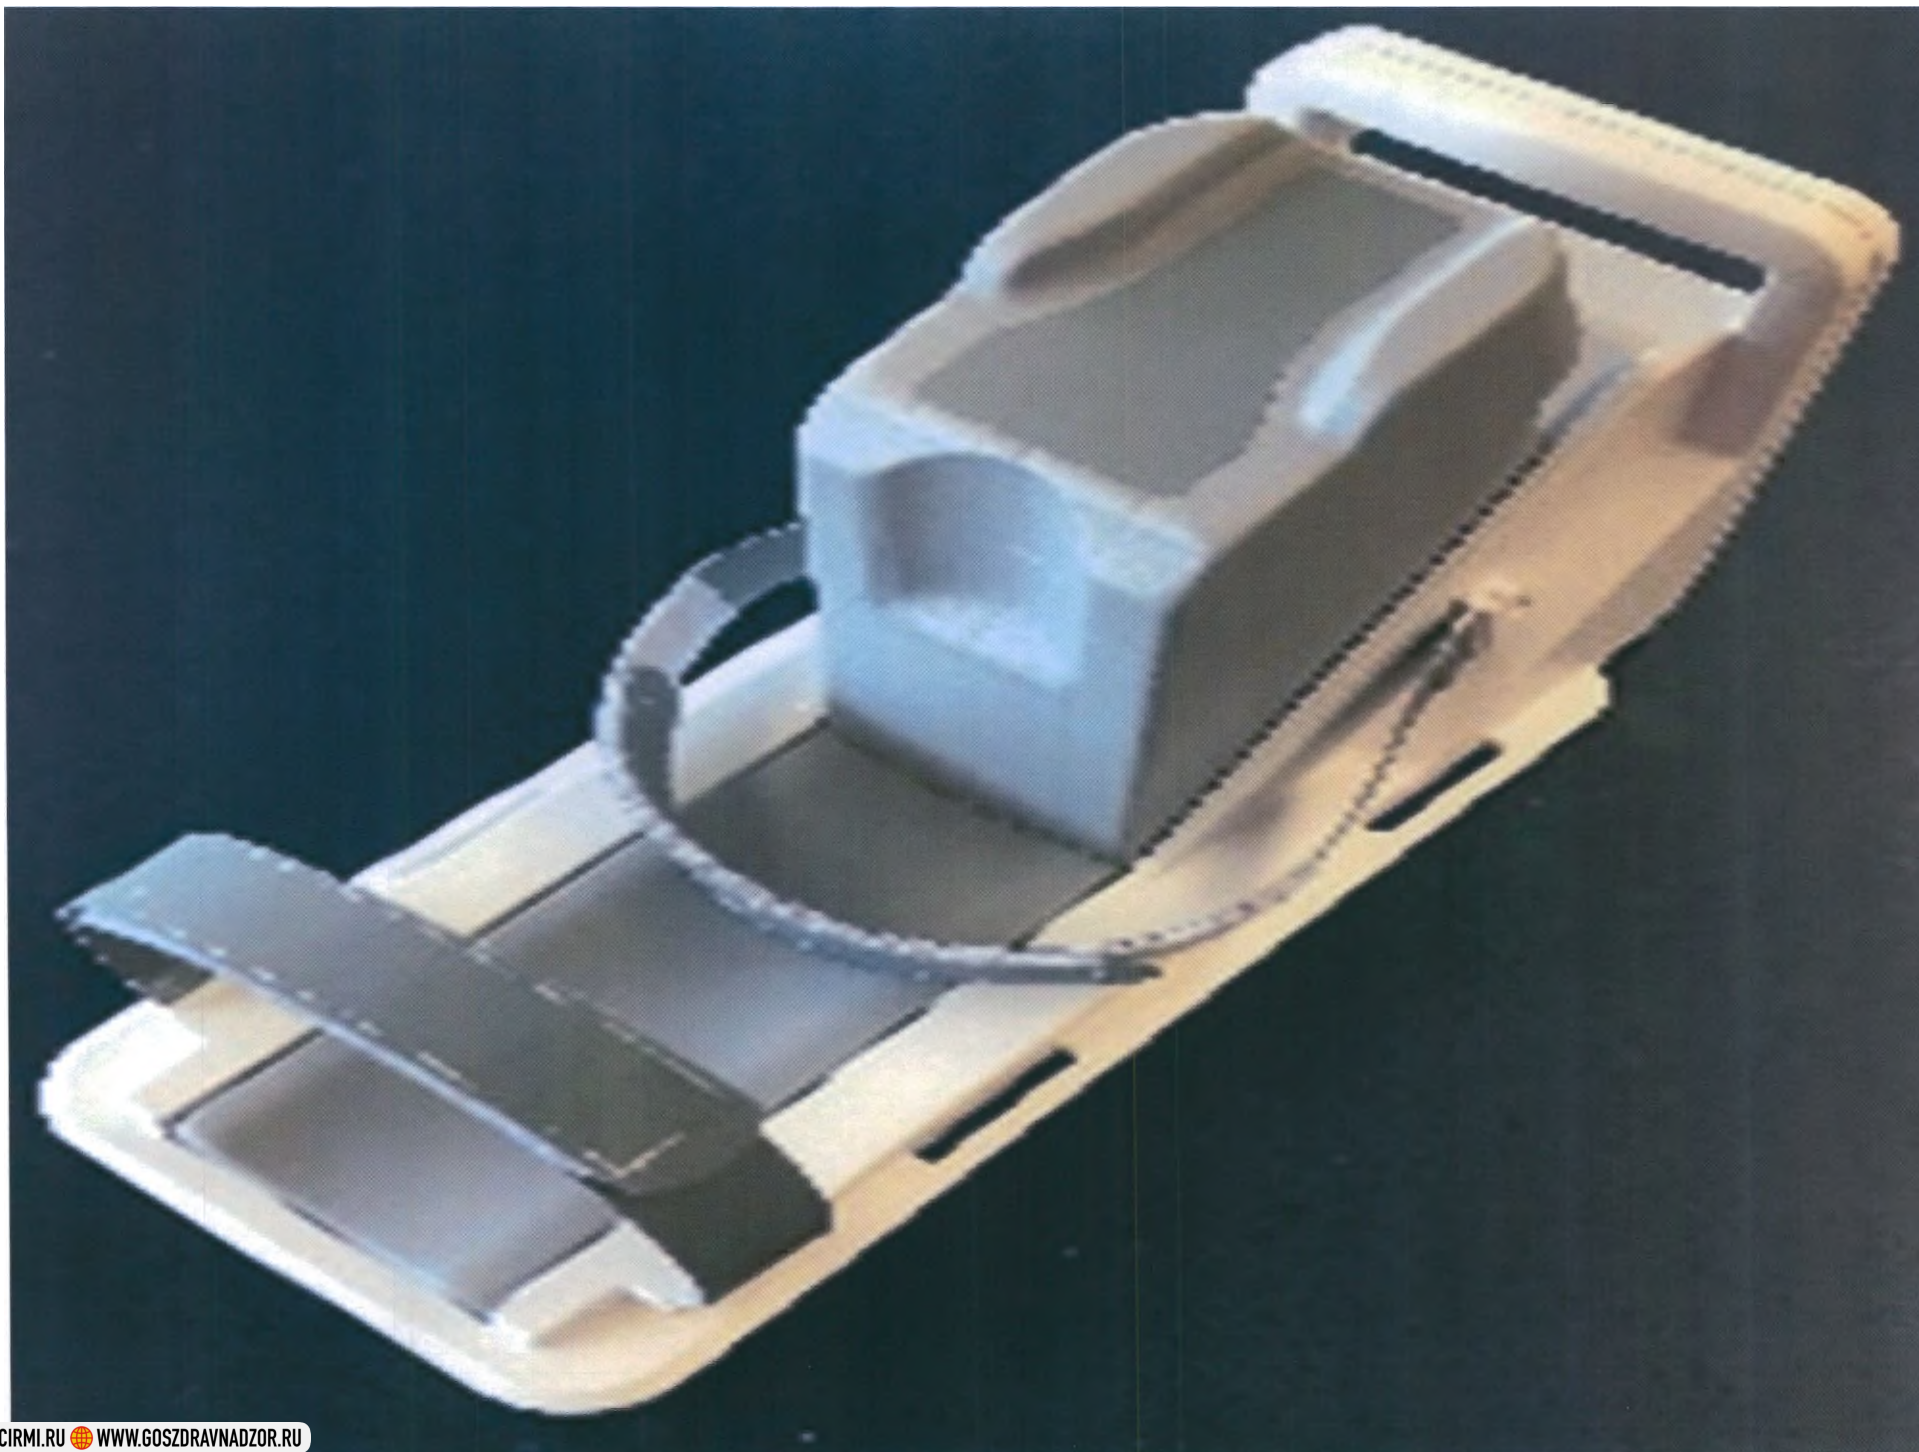

40. Устройство контроля физиологических данных




40. Устройство контроля физиологических данных



40. Устройство контроля физиологических данных



40. Устройство контроля физиологических данных

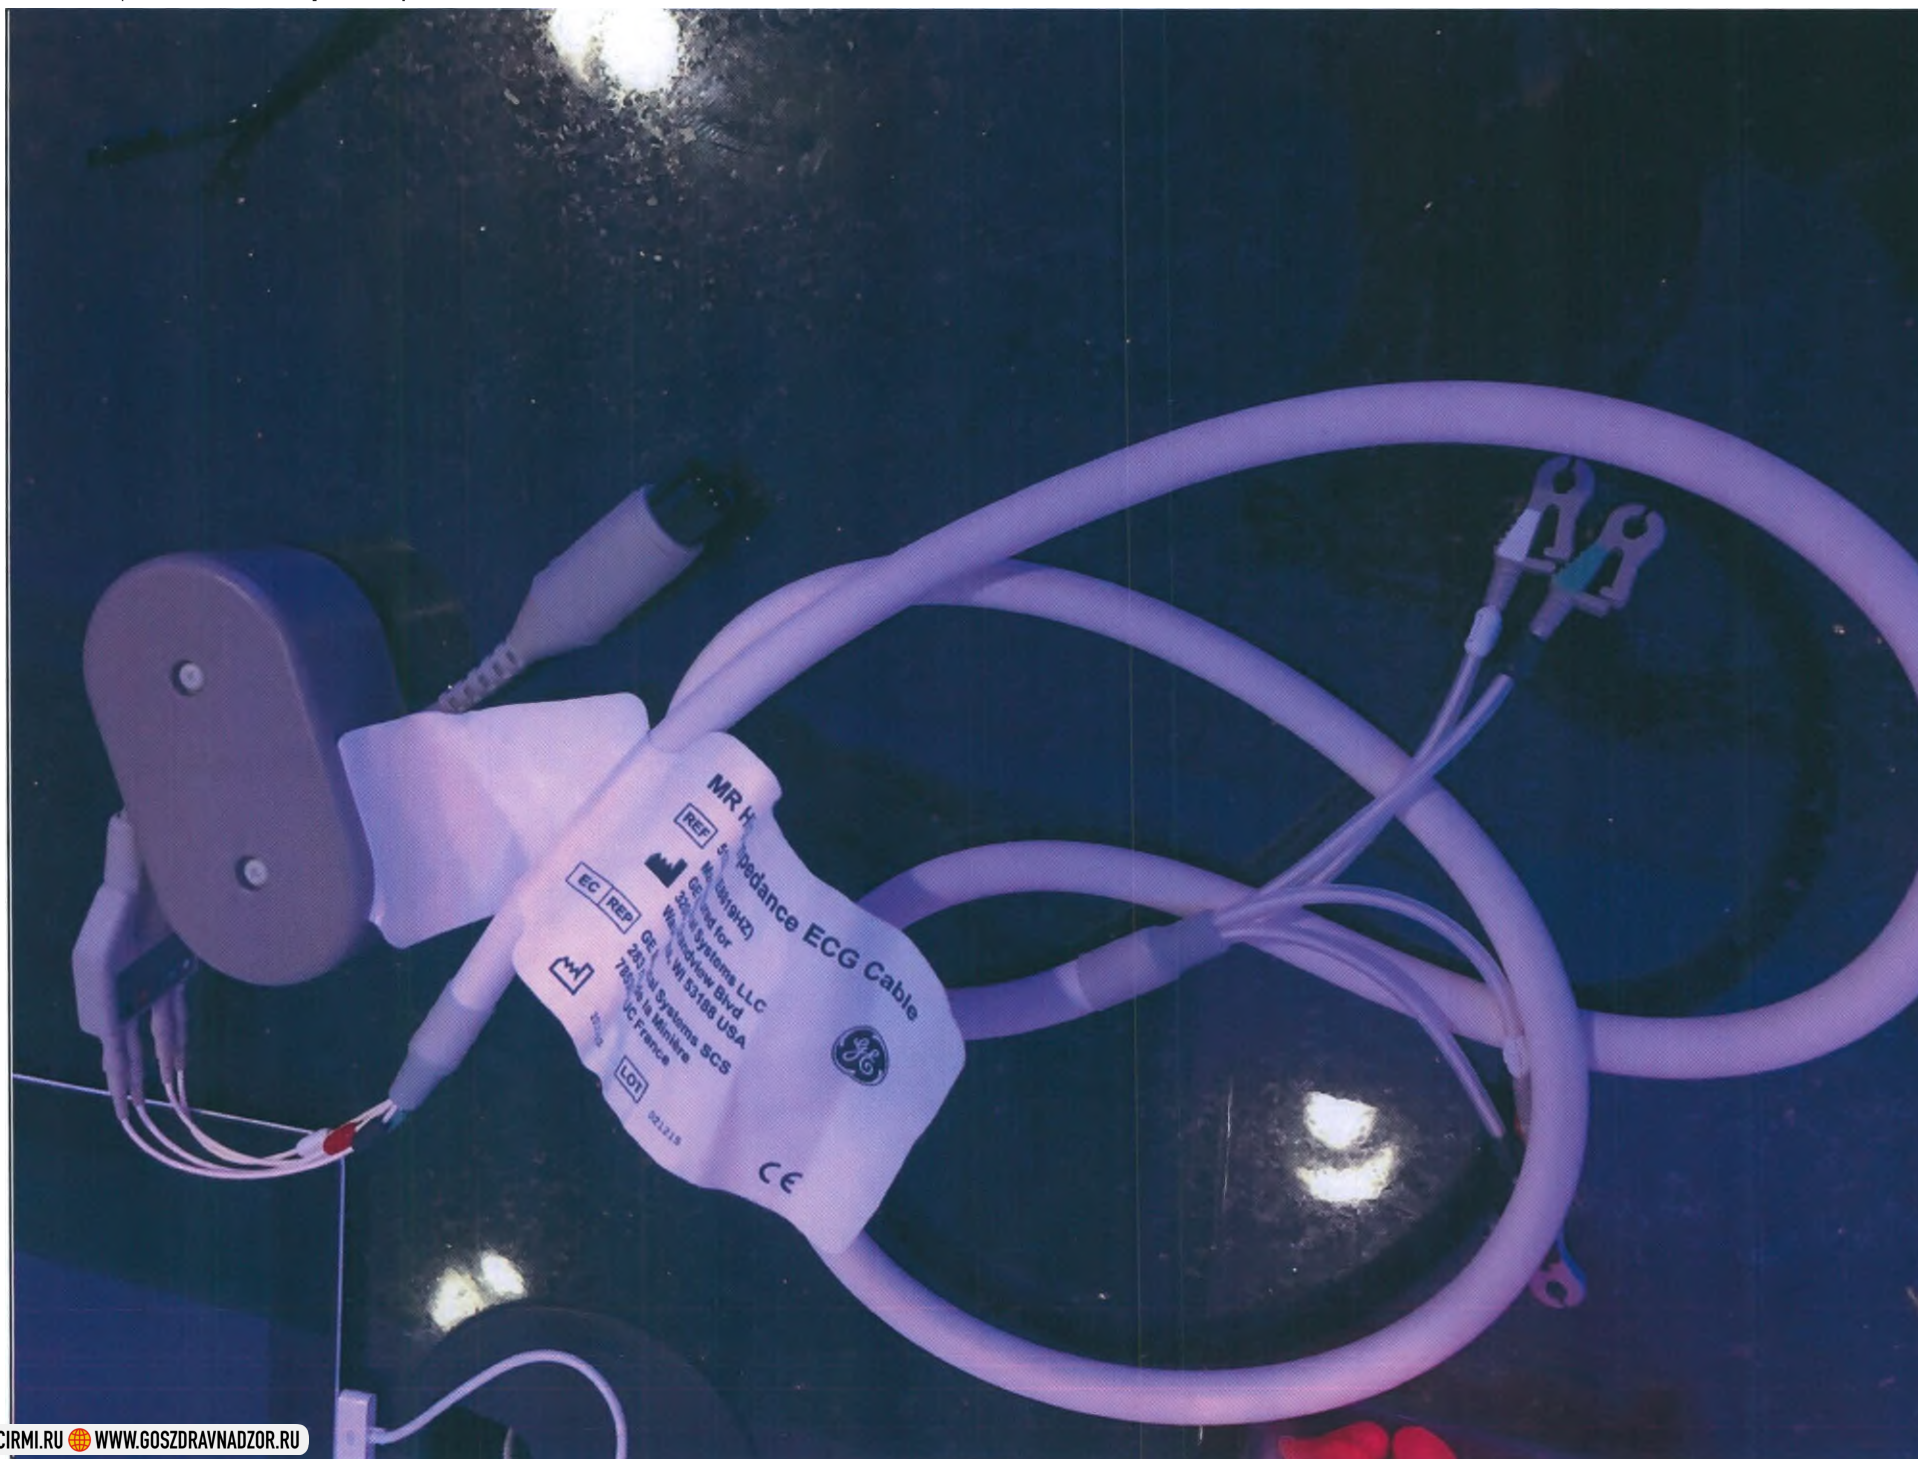

40. Устройство контроля физиологических данных



40. Устройство контроля физиологических данных



40. Устройство контроля физиологических данных



41. Устройство отключения магнита



41. Устройство отключения магнита





42. Фантомы



42. Фантомы (маркировка не читается)



42. Фантомы (маркировка не читается)

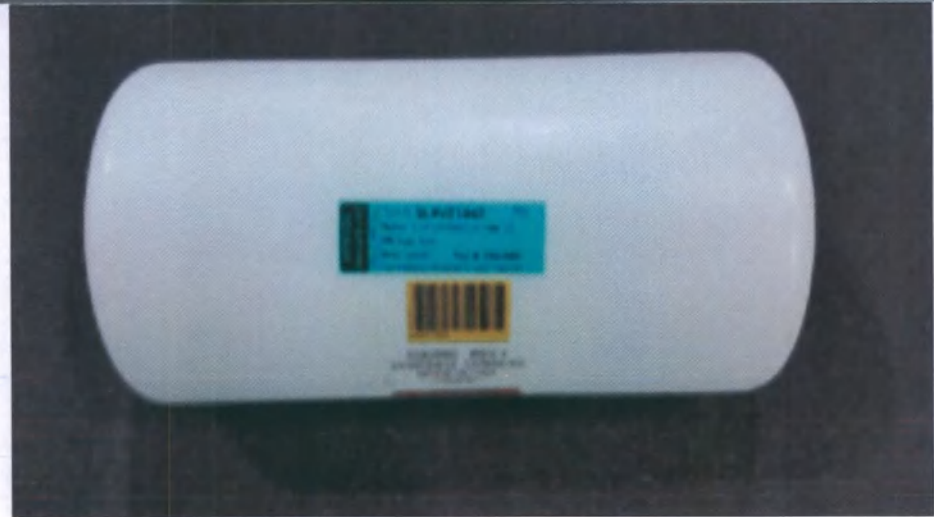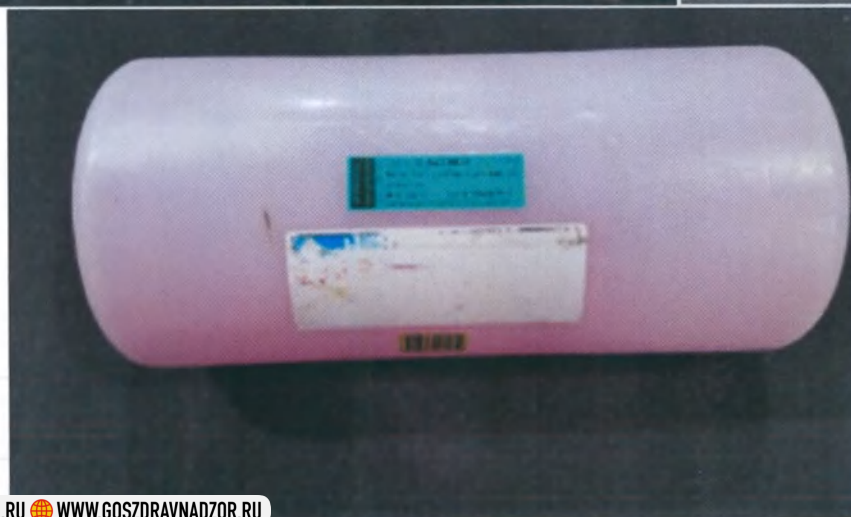

43. Рабочая станция врача для обработки данных




43. Рабочая станция врача для обработки данных



43. Рабочая станция врача для обработки данных



43. Рабочая станция врача для обработки данных

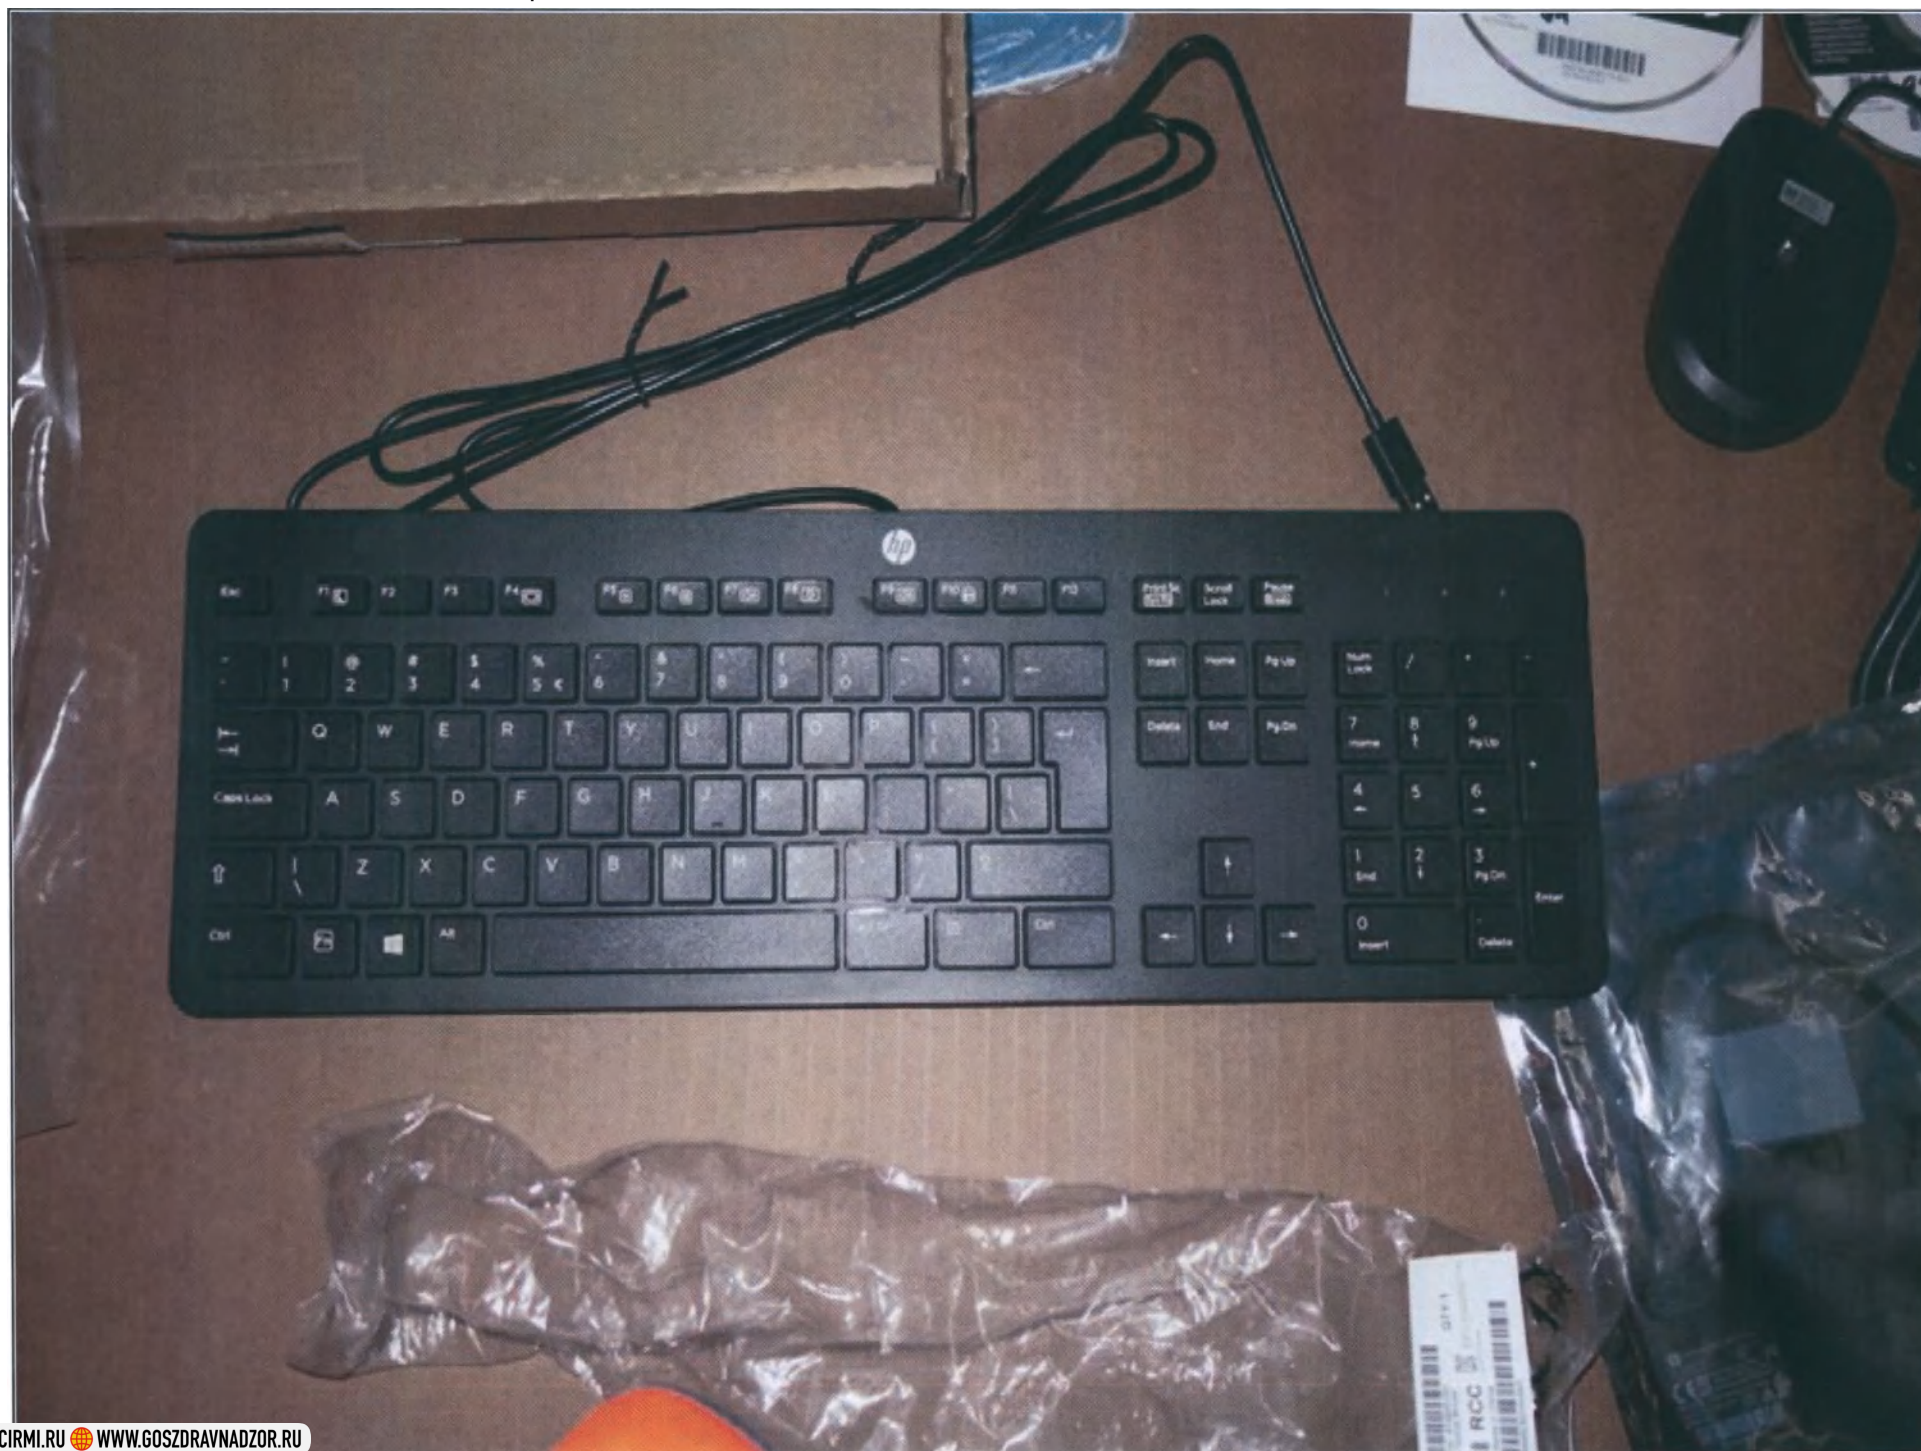

44. Рабочая станция врача для обработки данных серверного типа



44. Рабочая станция врача для обработки данных серверного типа



44. Рабочая станция врача для обработки данных серверного типа




44. Рабочая станция врача для обработки данных серверного типа



45. Щит силовой распределительный




45. Щит силовой распределительный

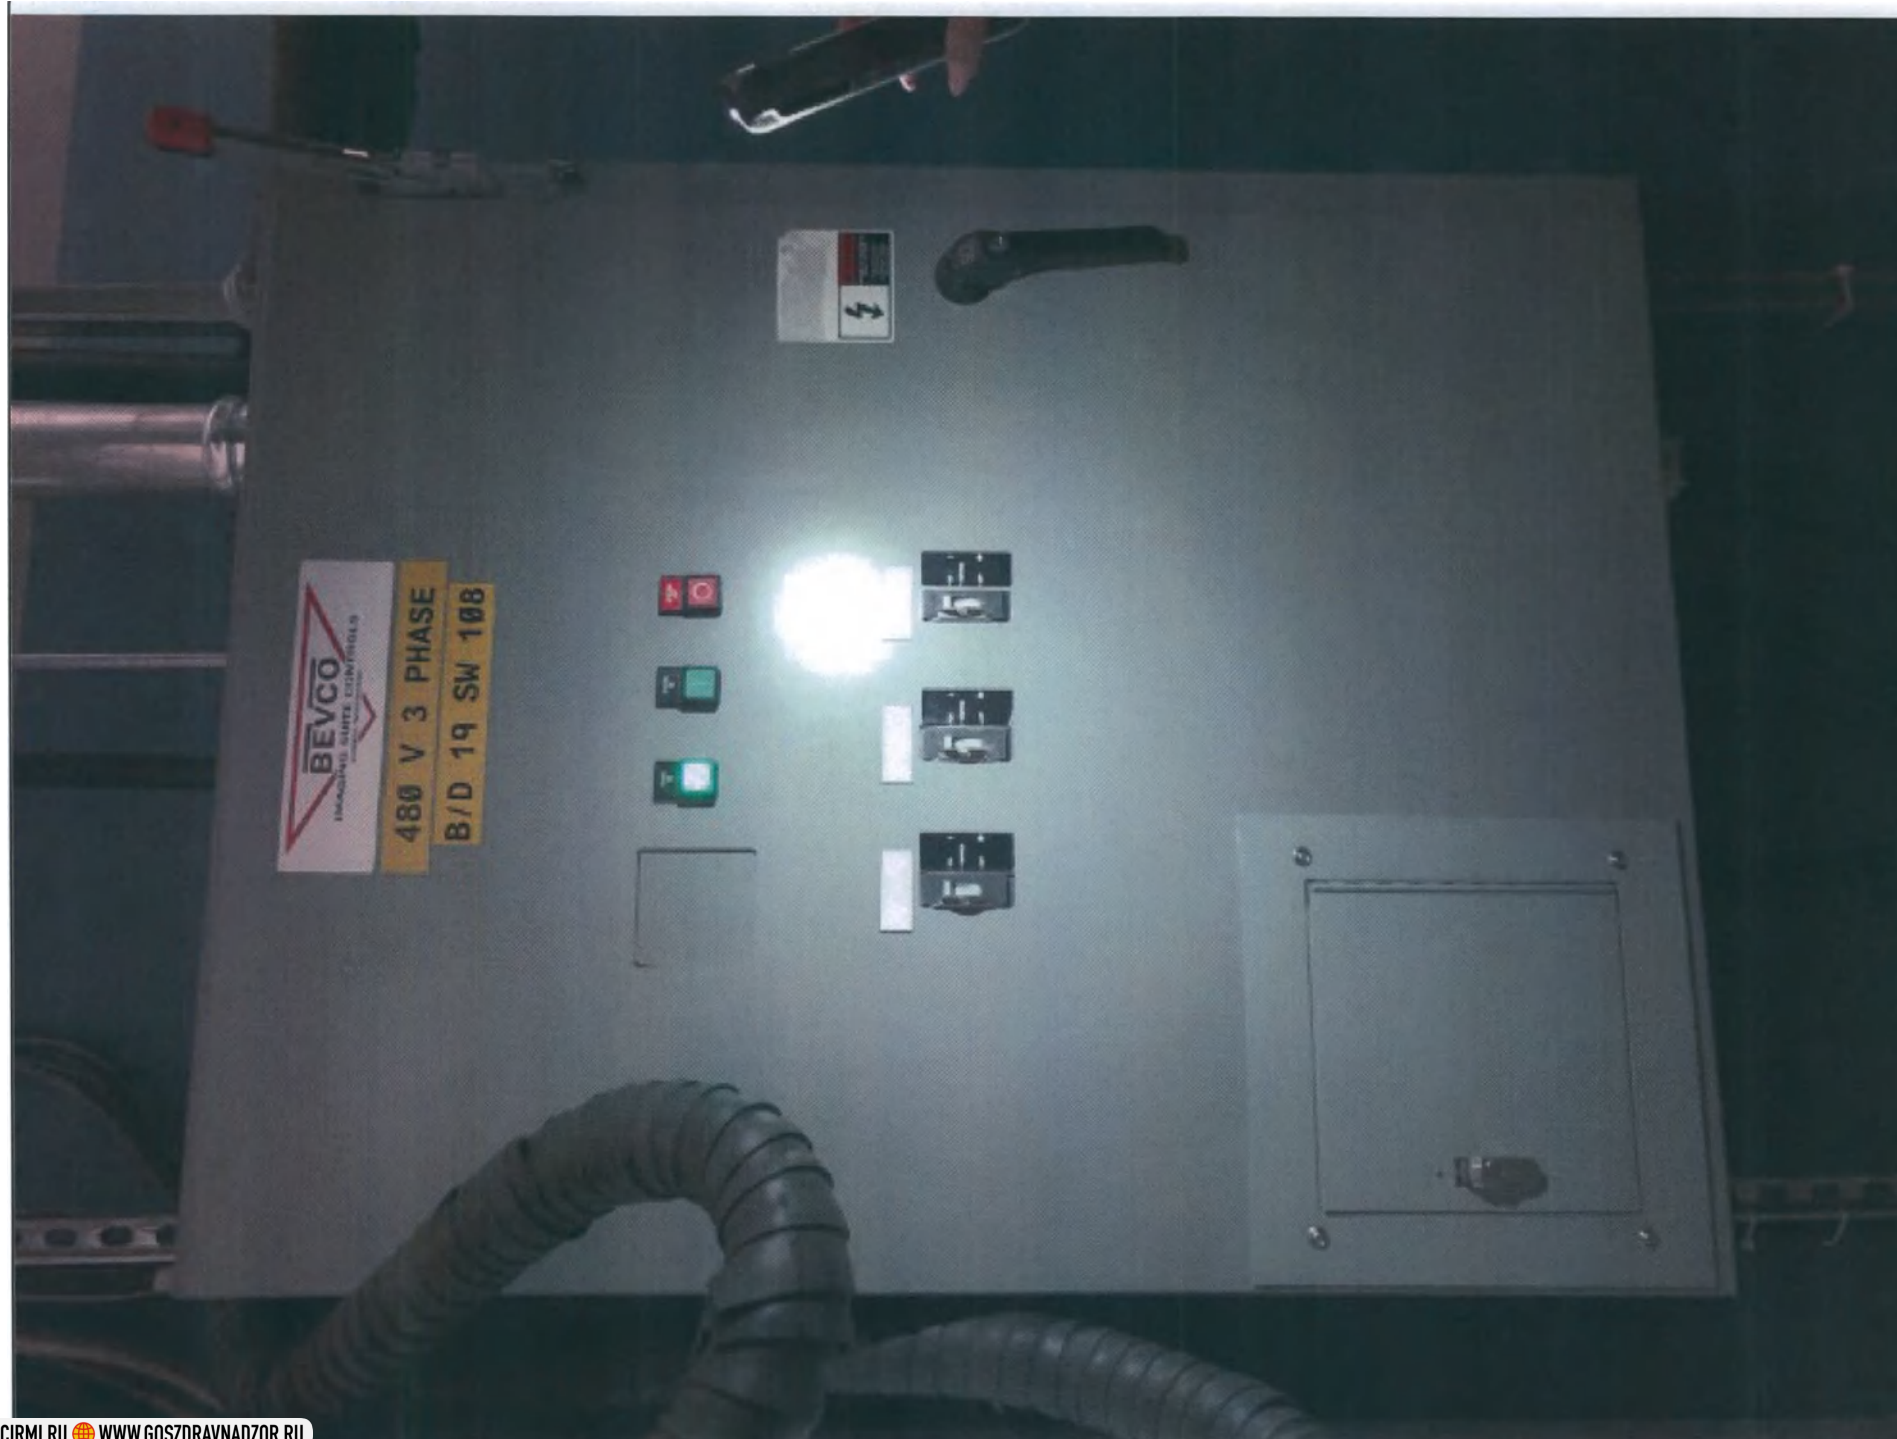


45. Щит силовой распределительный




45. Щит силовой распределительный

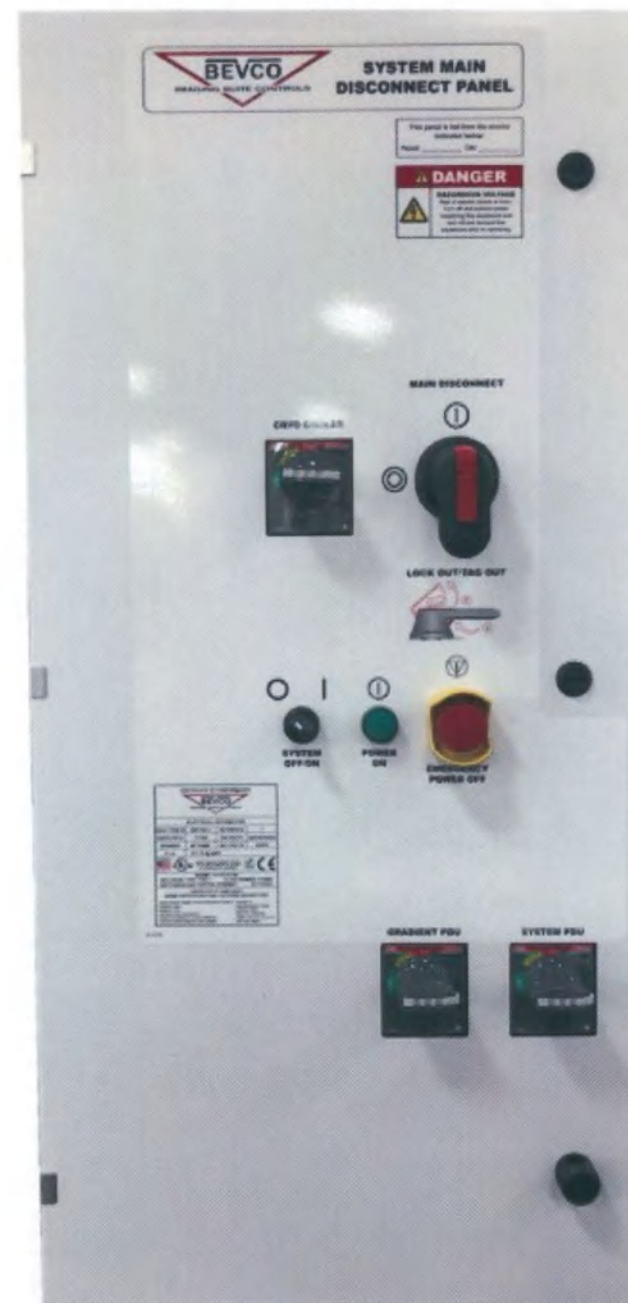

46. Расходные материалы для немагнитного инъектора

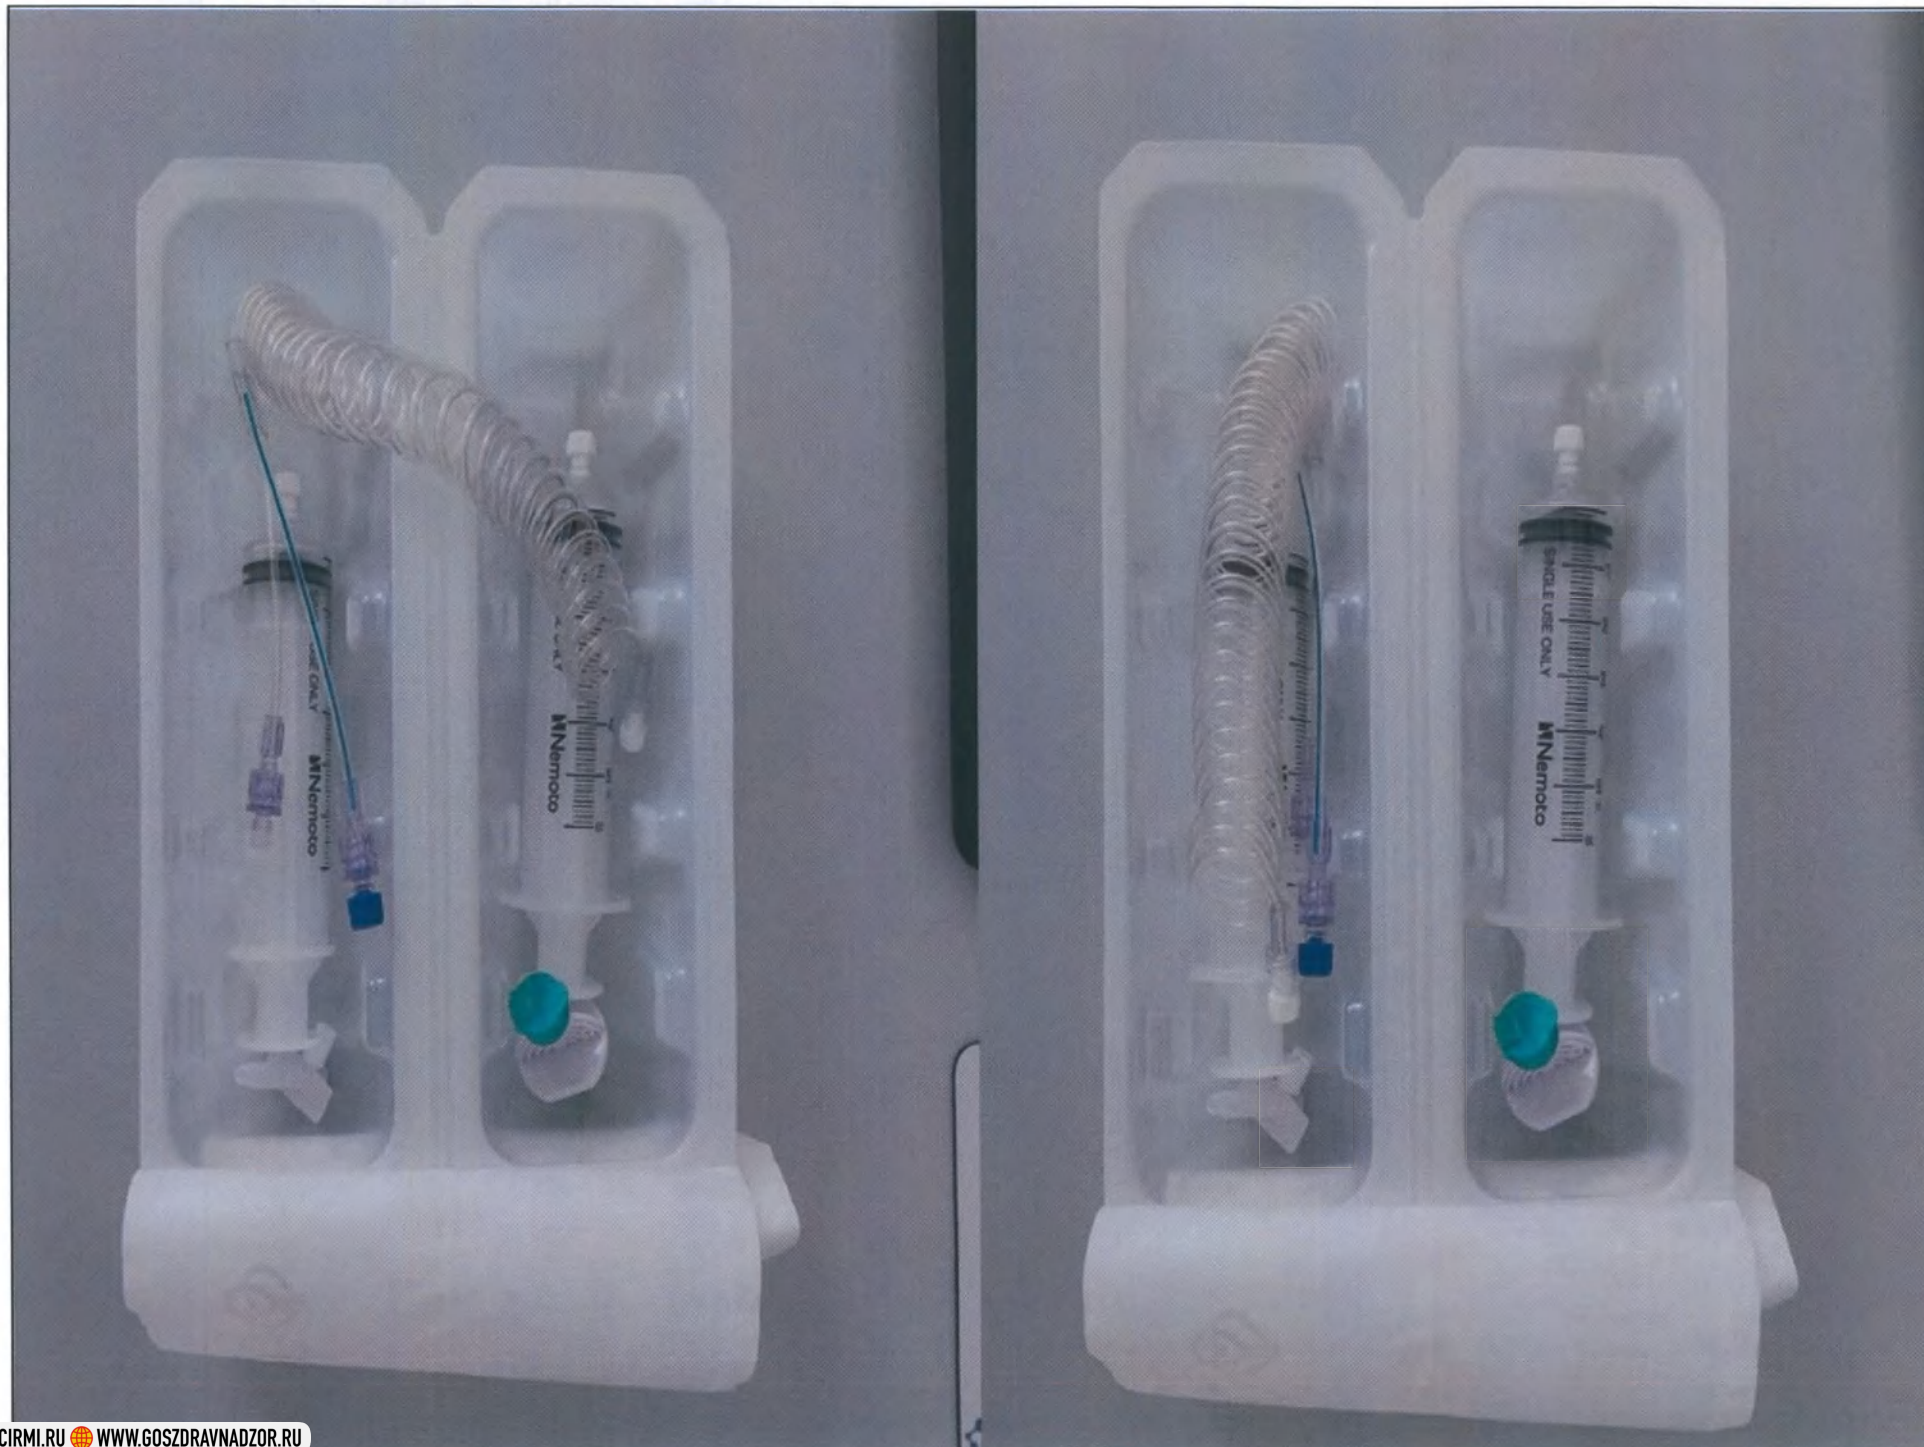

46. Расходные материалы для немагнитного инъектора

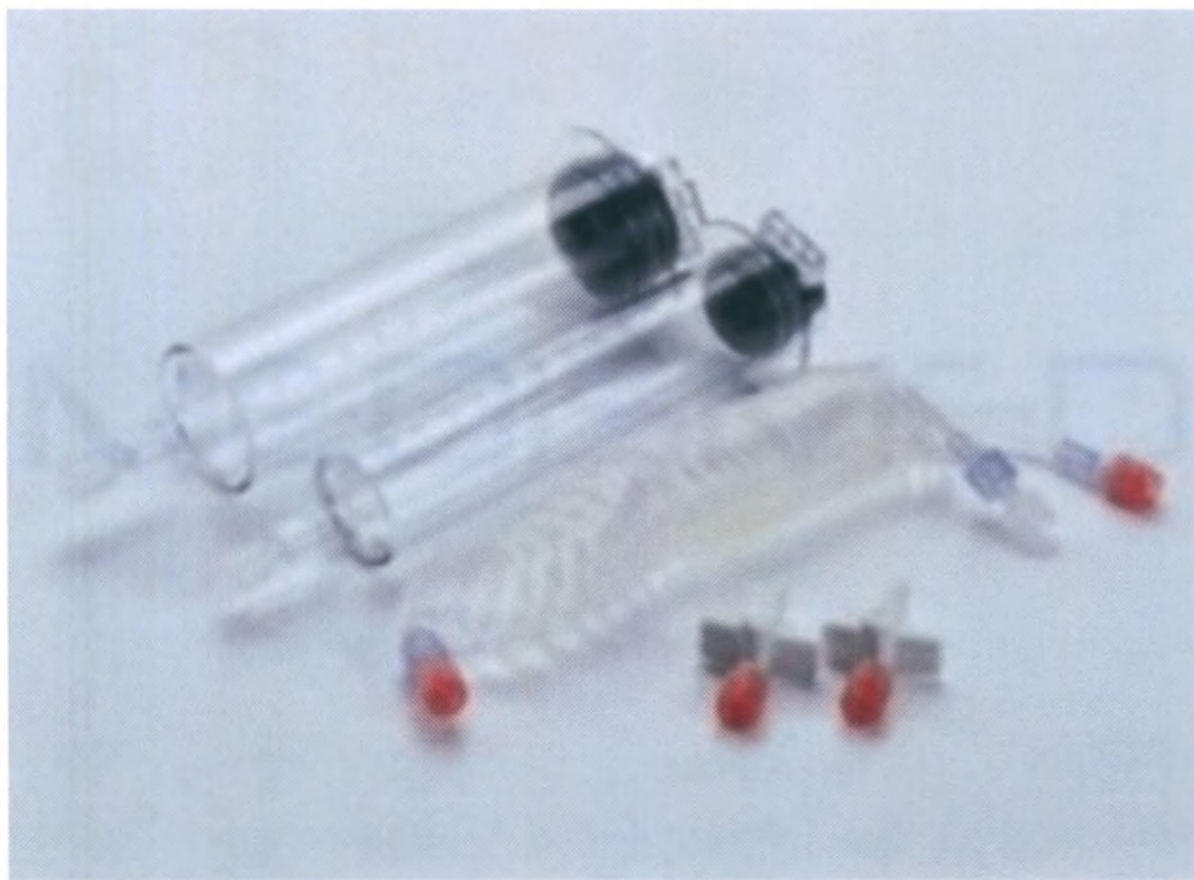

47. Инъектор немагнитный для ввода контраста для МР-томографов




47. Инъектор немагнитный для ввода контраста для МР-томографов



47. Инъектор немагнитный для ввода контраста для МР-томографов



48. Специализированные лазеры для разметки при планировании лучевой терапии

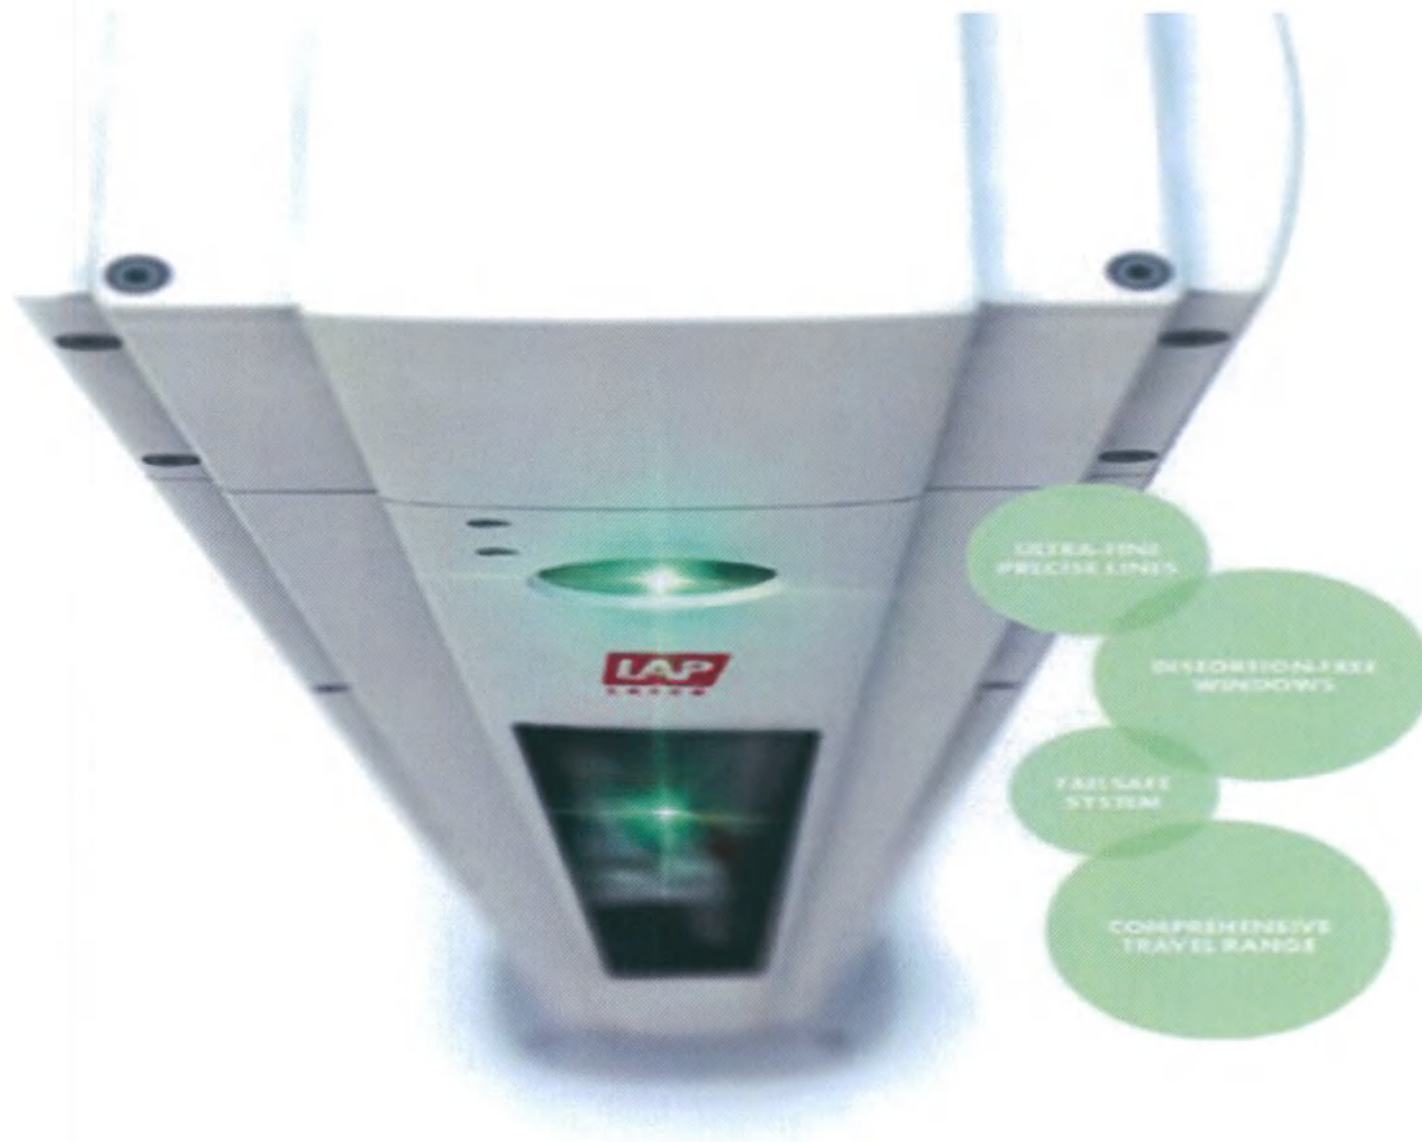


48. Специализированные лазеры для разметки при планировании лучевой терапии




49. Устройство для многоядерной спектроскопии





49. Устройство для многоядерной спектроскопии

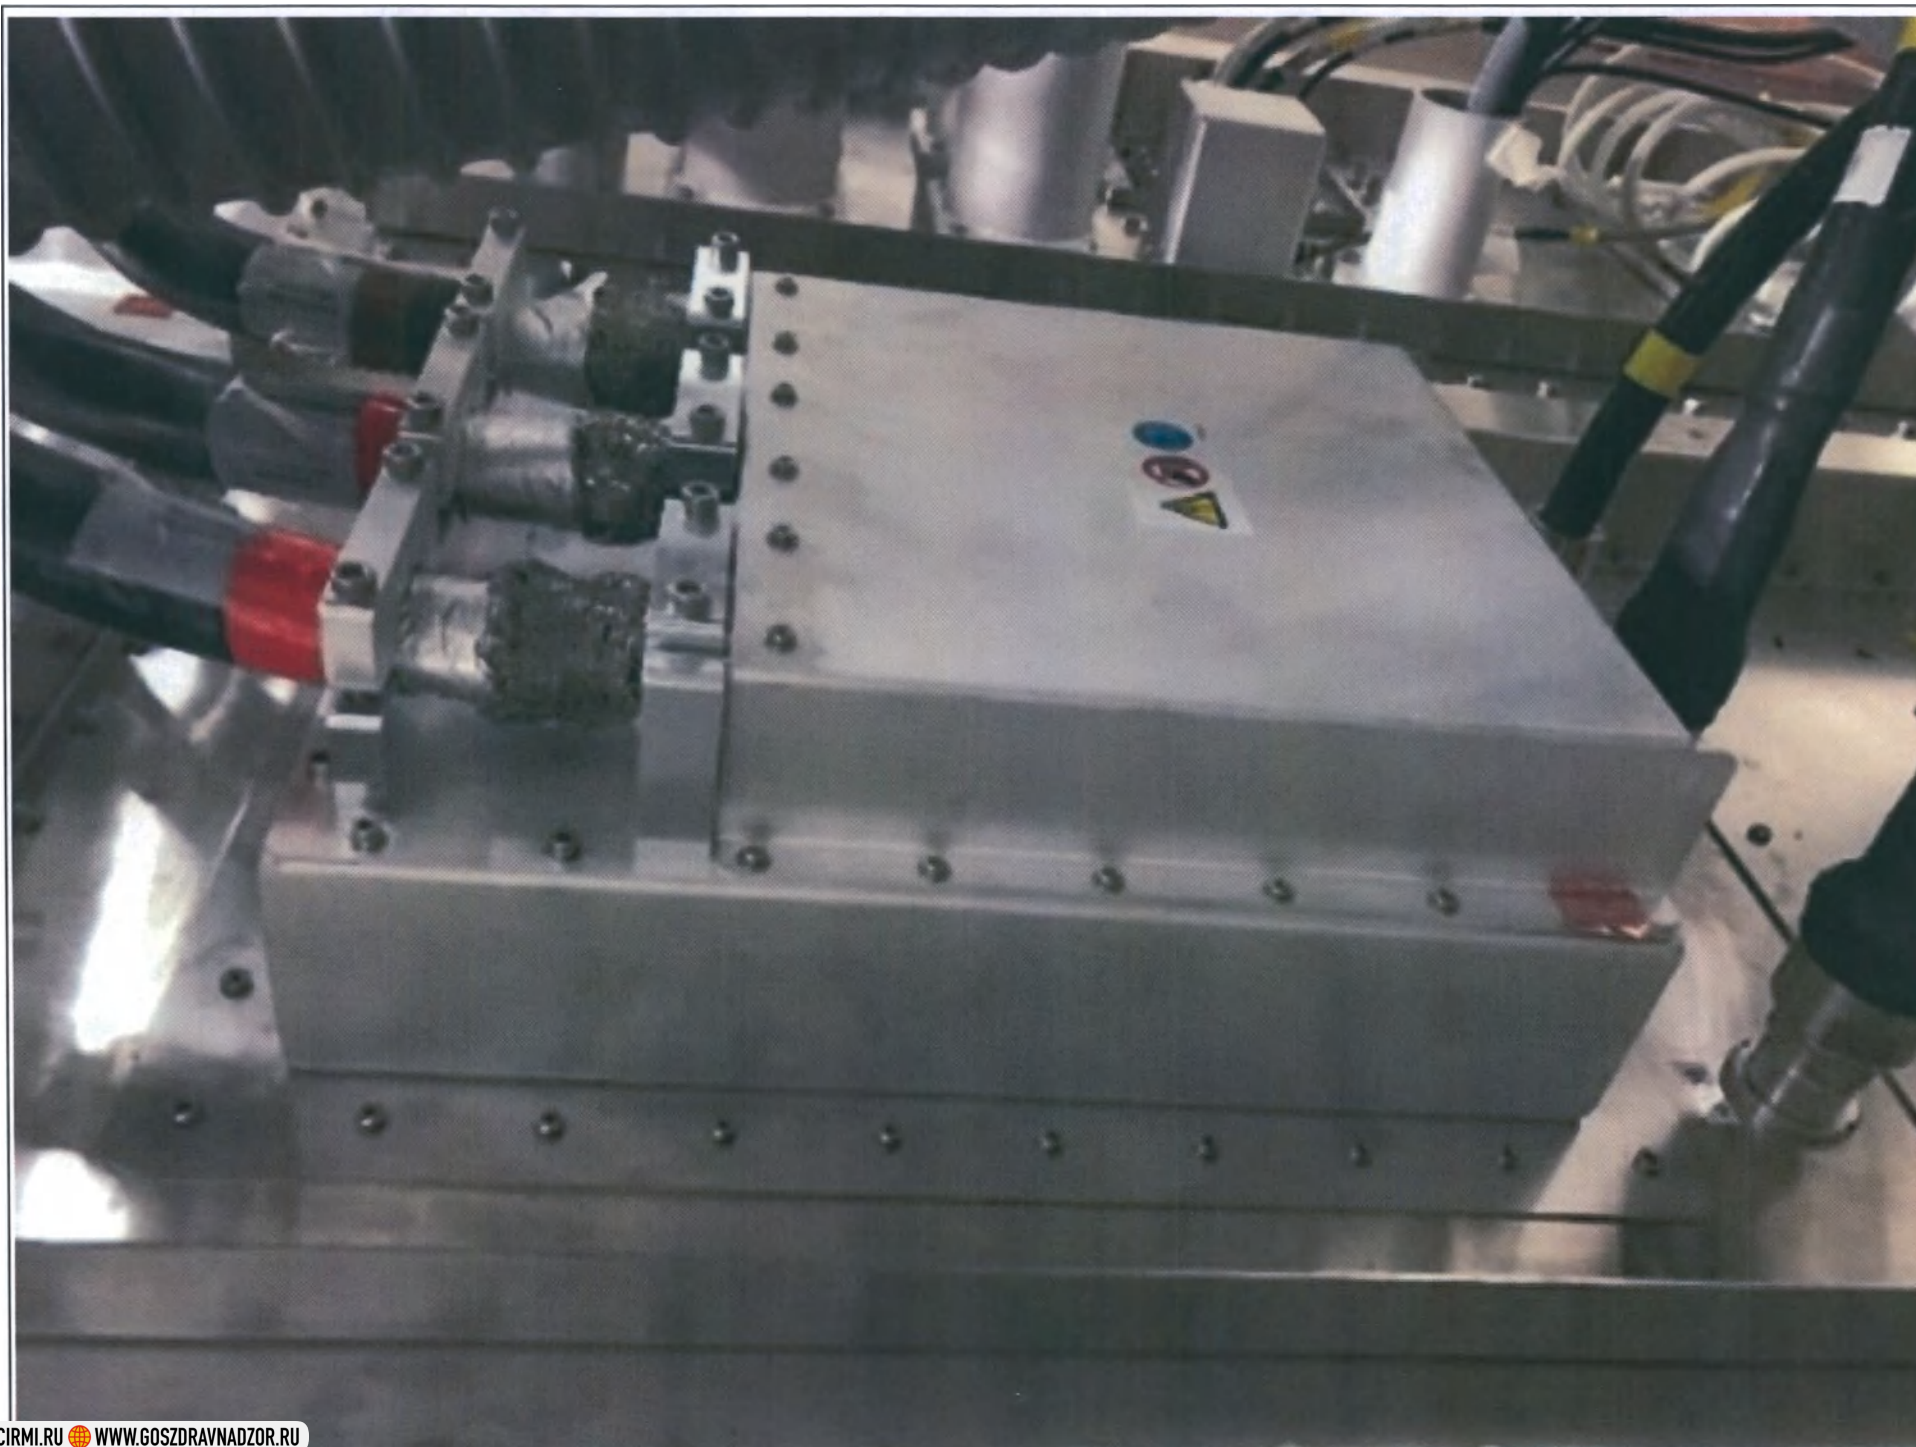


49. Устройство для многоядерной спектроскопии

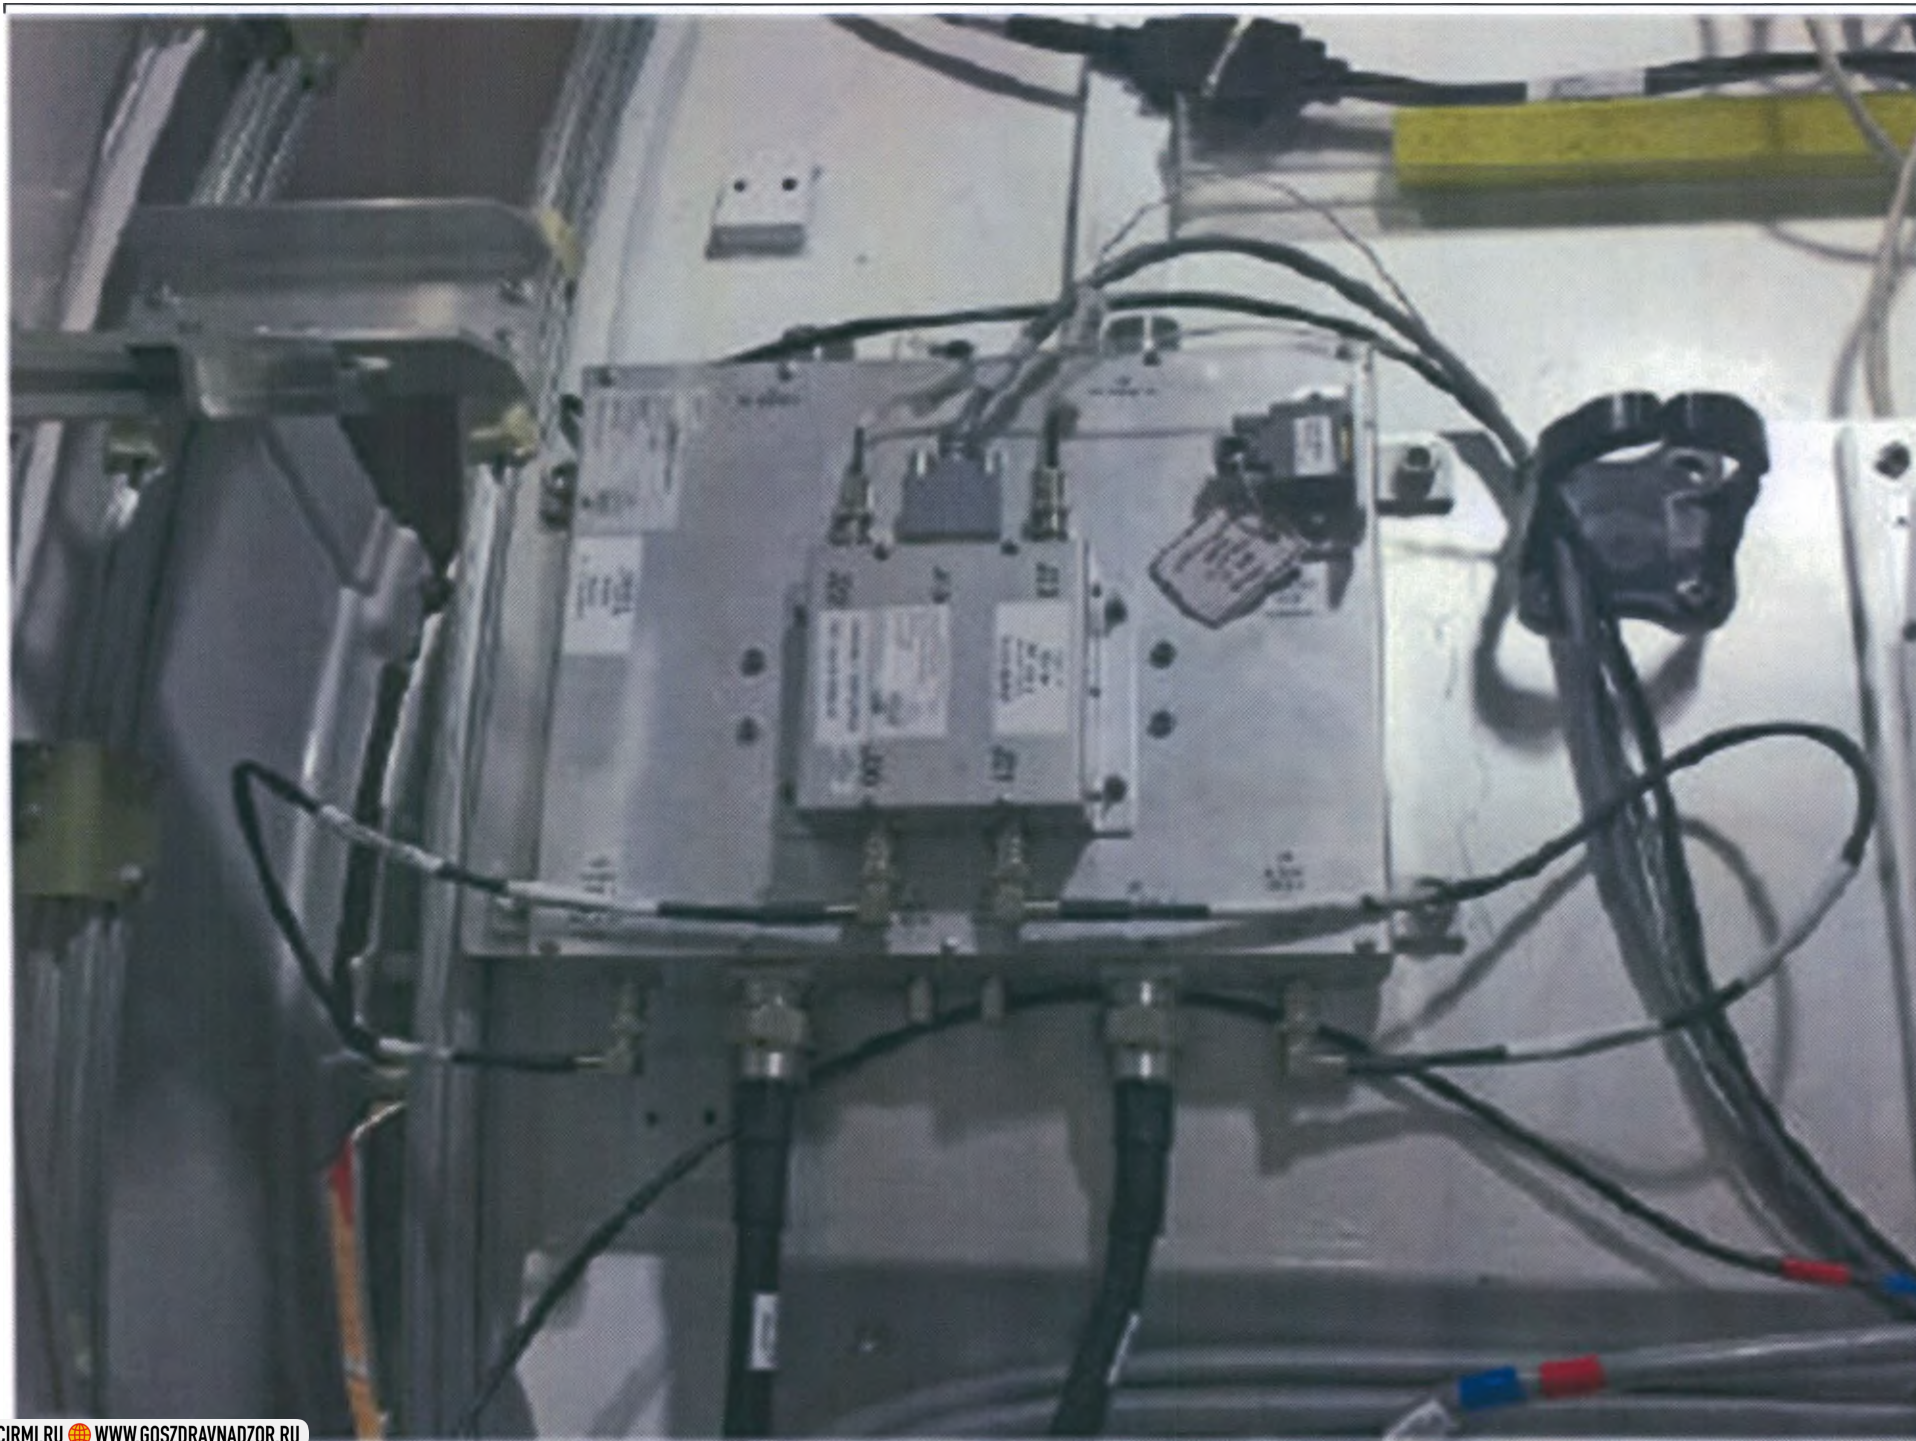

49. Устройство для многоядерной спектроскопии

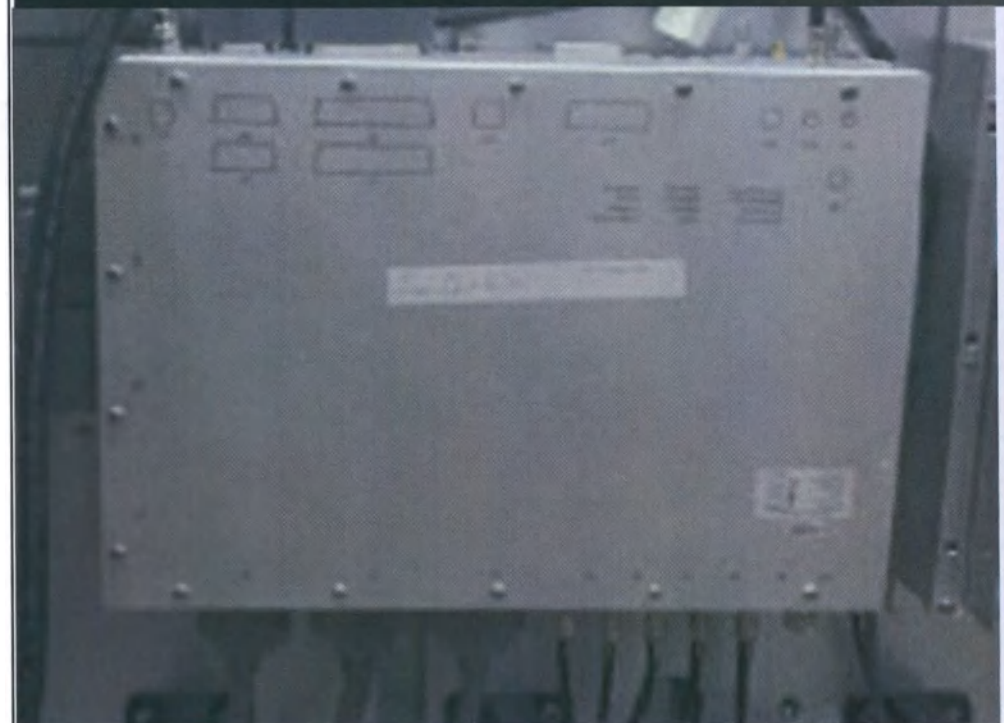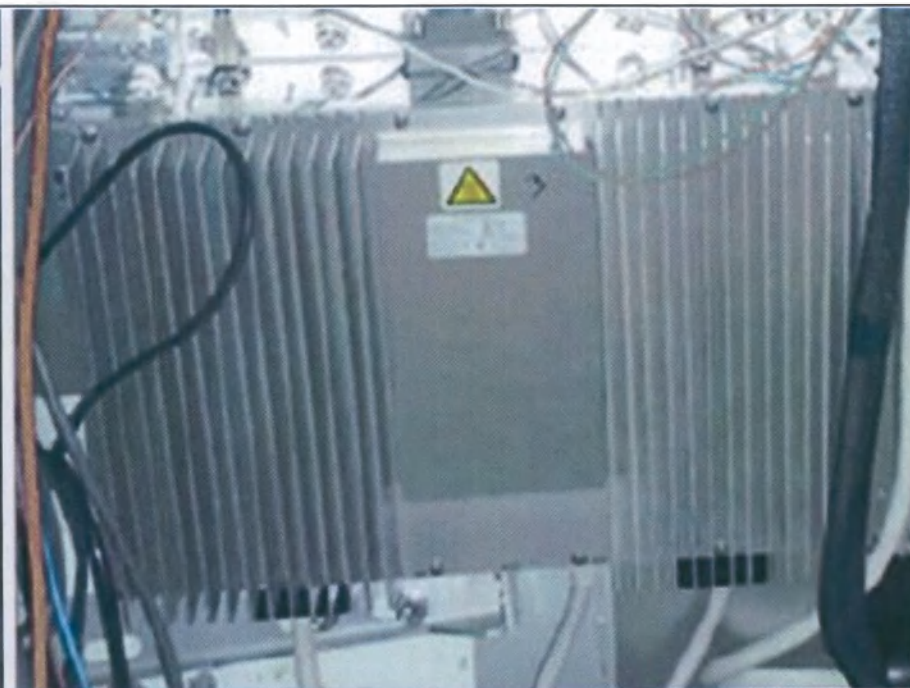

49. Устройство для многоядерной спектроскопии

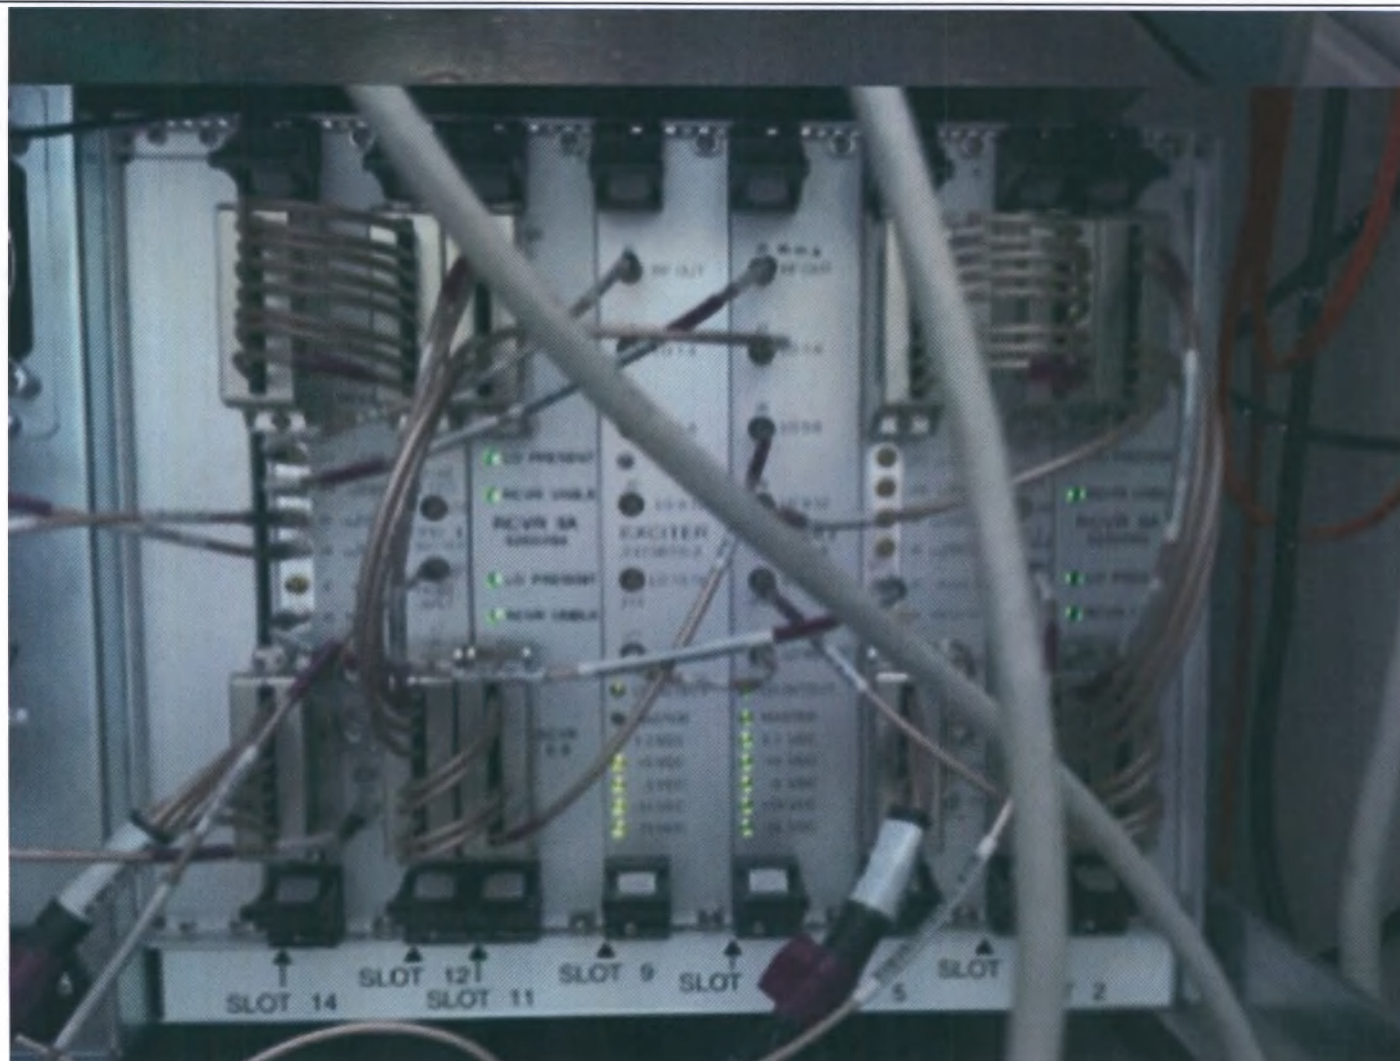

50. Цветные мониторы медицинские



50. Цветные мониторы медицинские



50. Цветные мониторы медицинские



50. Цветные мониторы медицинские



51. Наушники для снижения акустического шума во время исследования



51. Наушники для снижения акустического шума во время исследования



51. Наушники для снижения акустического шума во время исследования



52. МРТ совместимое аудиоустройство и комплектующие



52. МРТ совместимое аудиоустройство и комплектующие



МРТ совместимое аудиоустройство и комплектующие




52. МРТ совместимое аудиоустройство и комплектующие




53. Устройство для защитного экранирования помещения



54. Декоративные наклейки

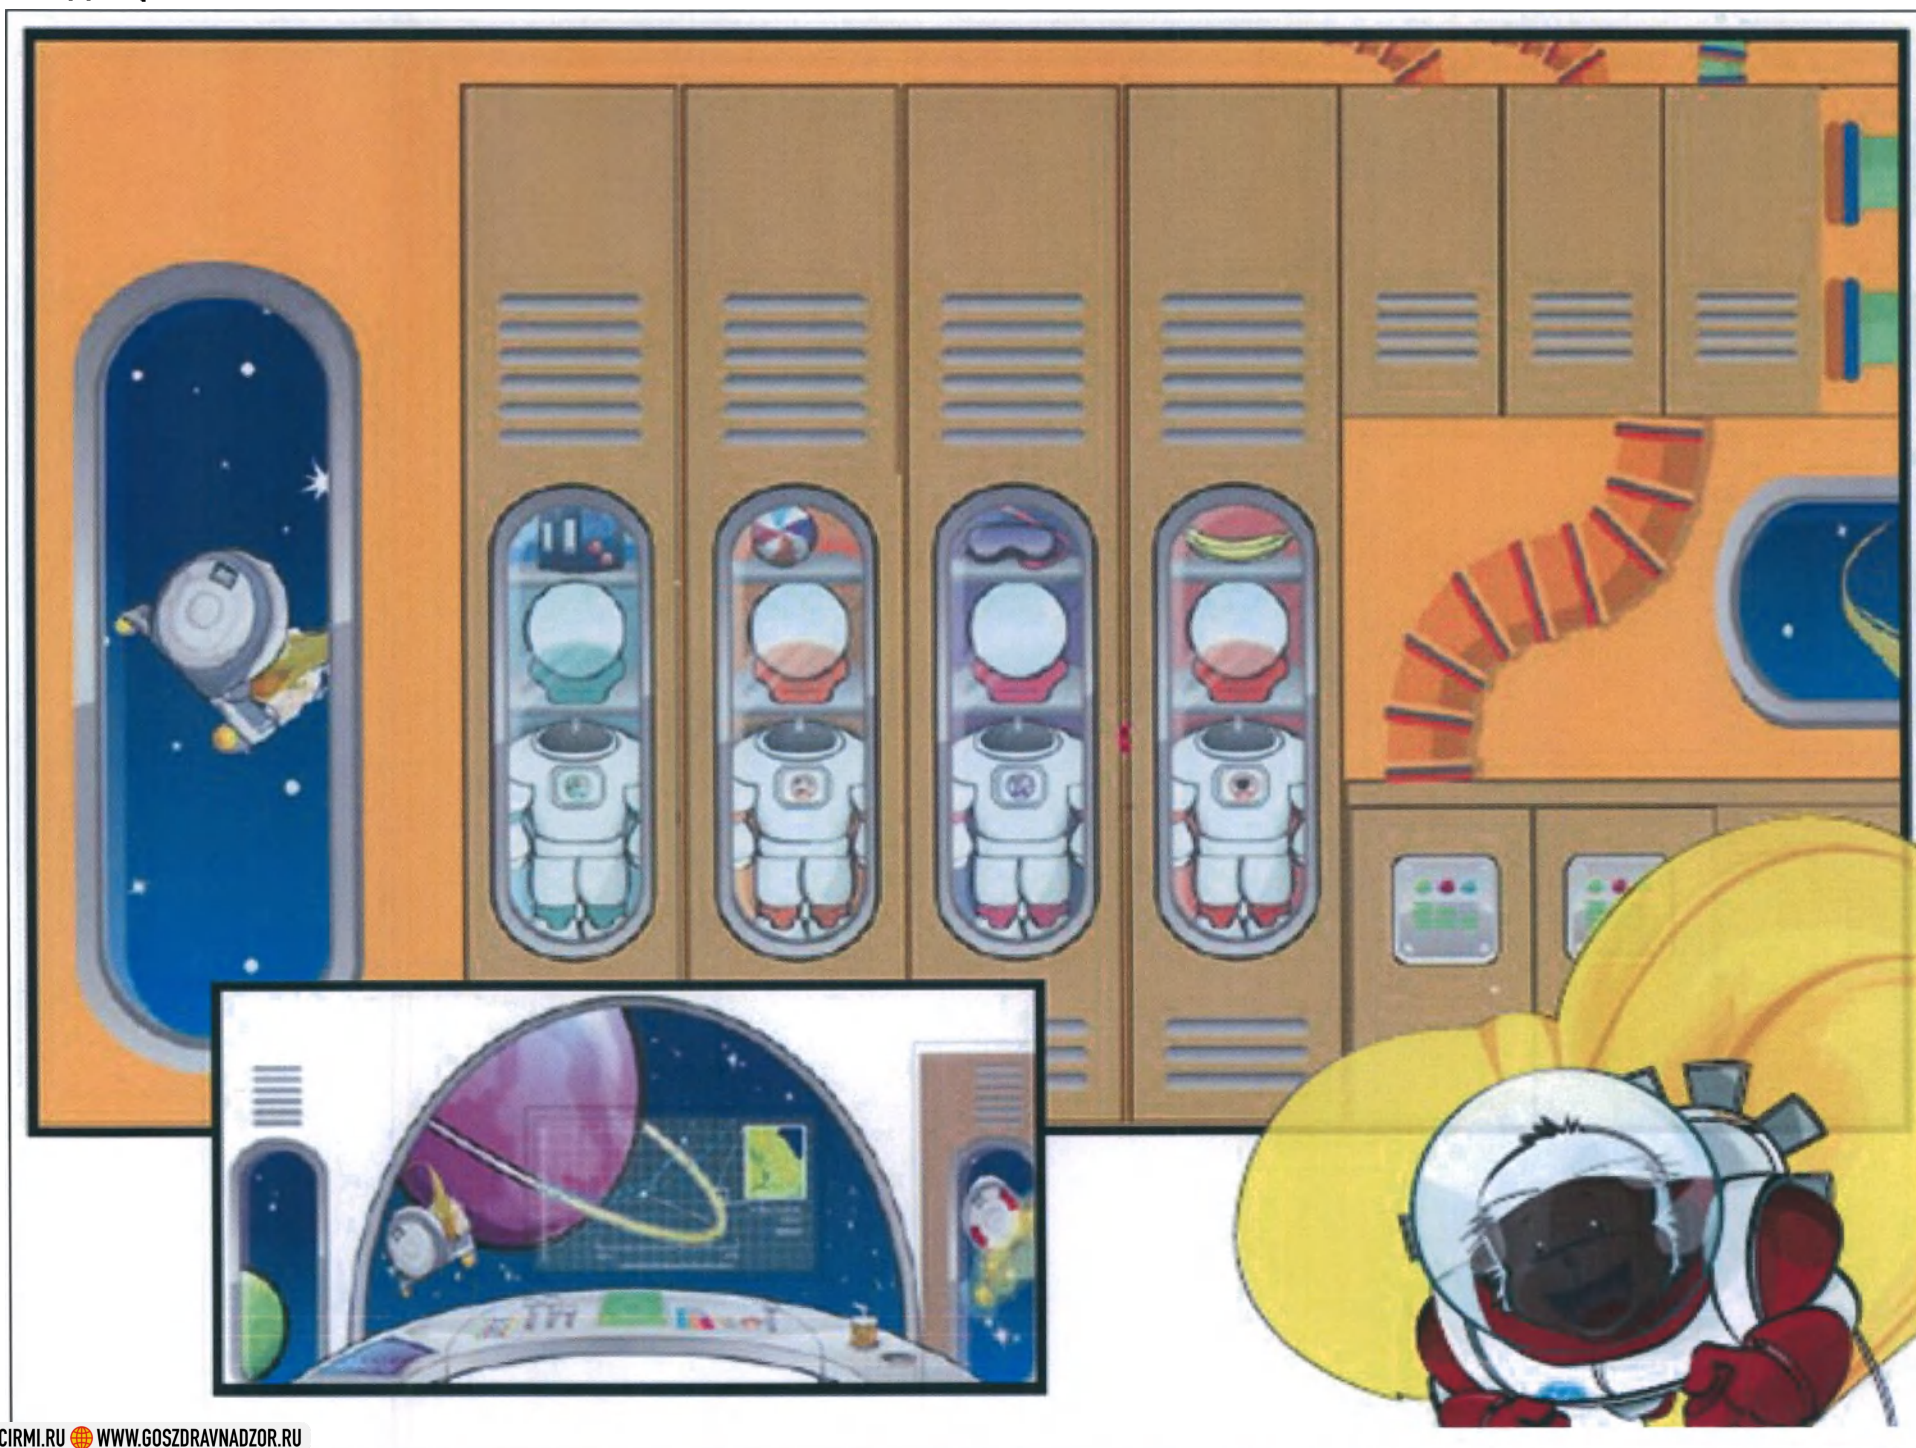

54. Декоративные наклейки

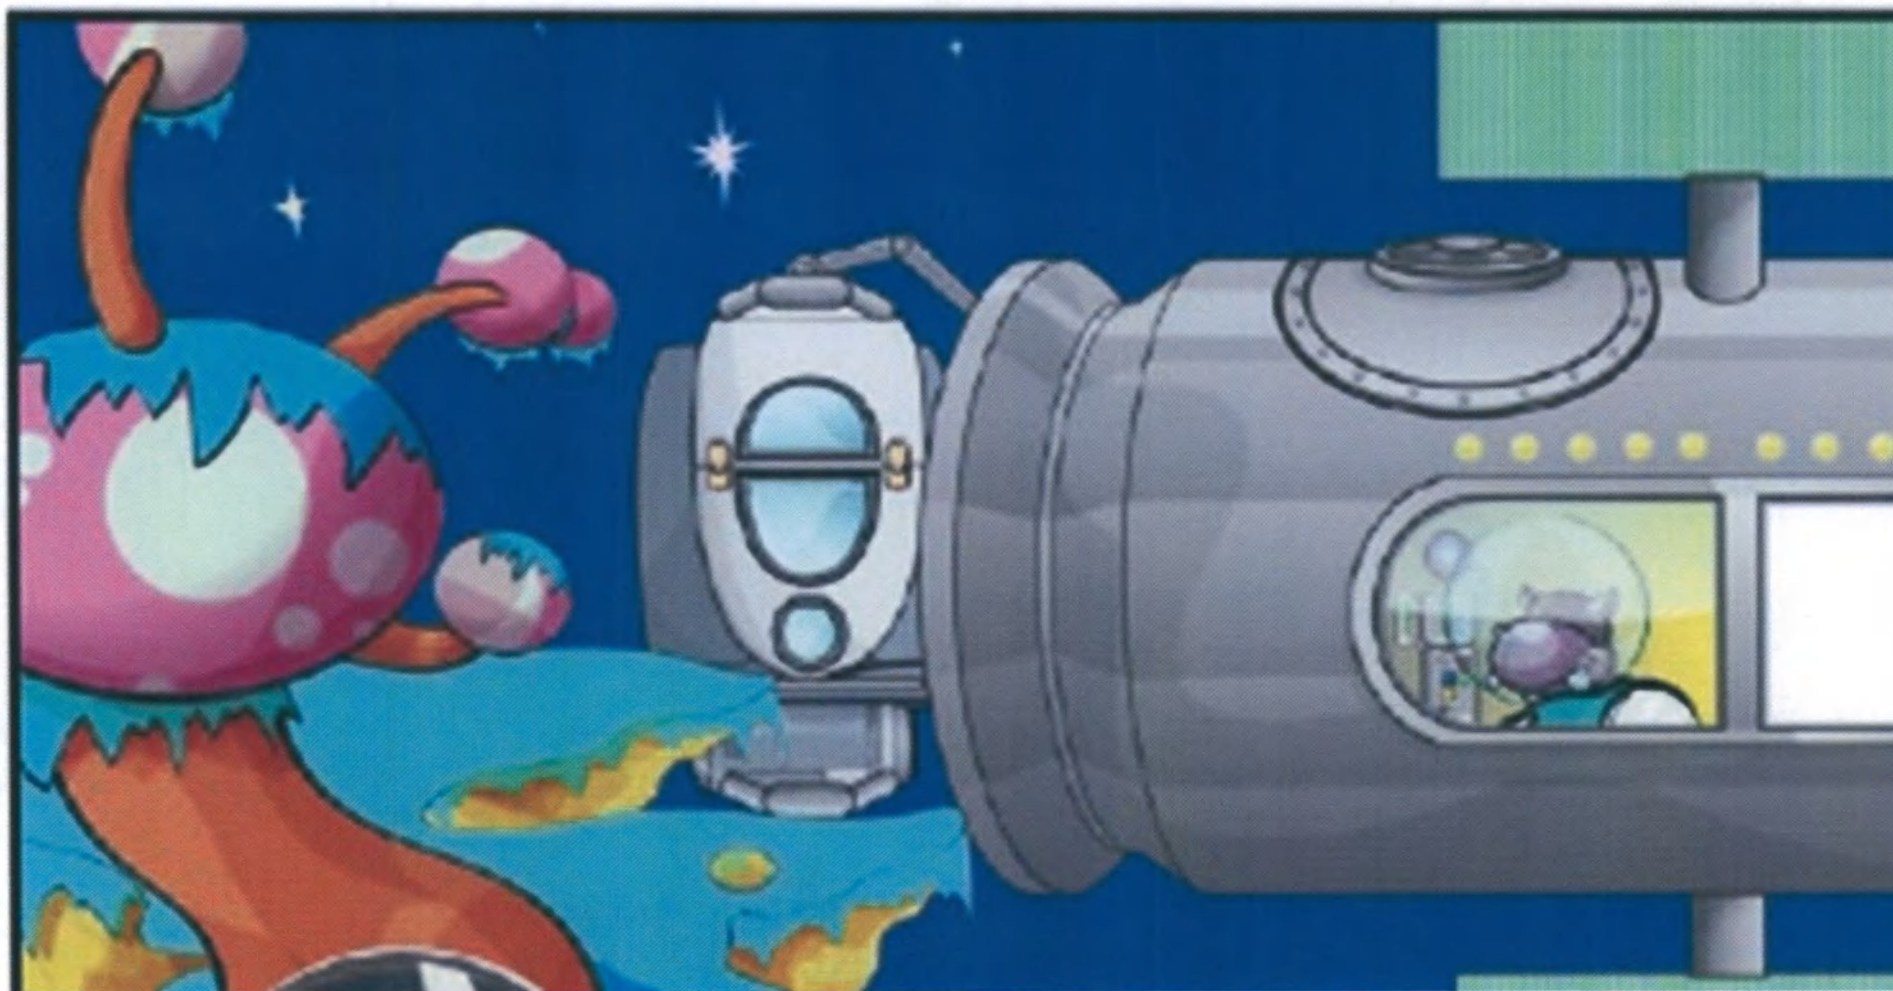


54. Декоративные наклейки




54. Декоративные наклейки



54. Декоративные наклейки

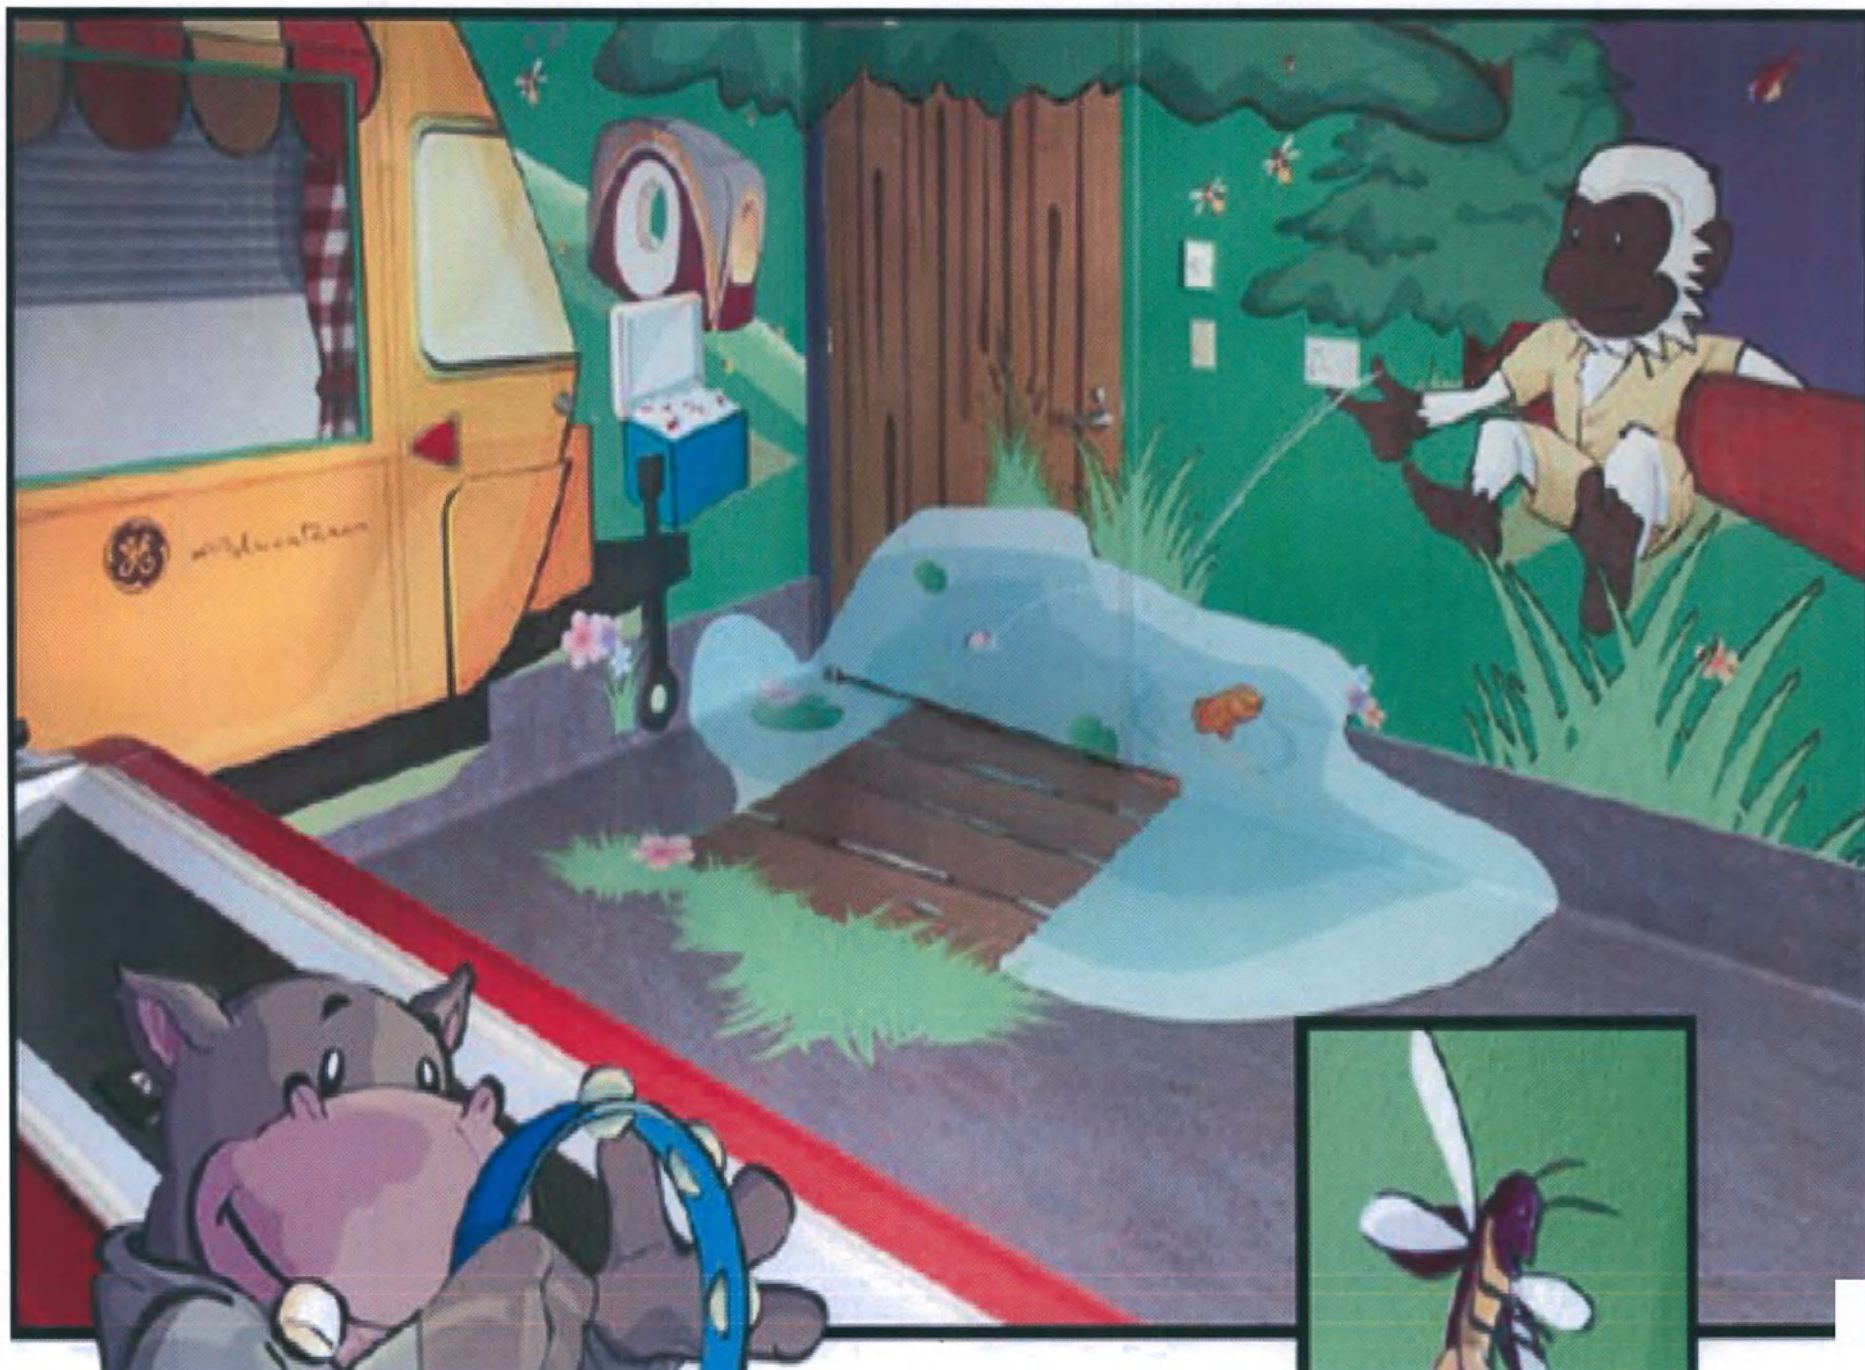

54. Декоративные наклейки

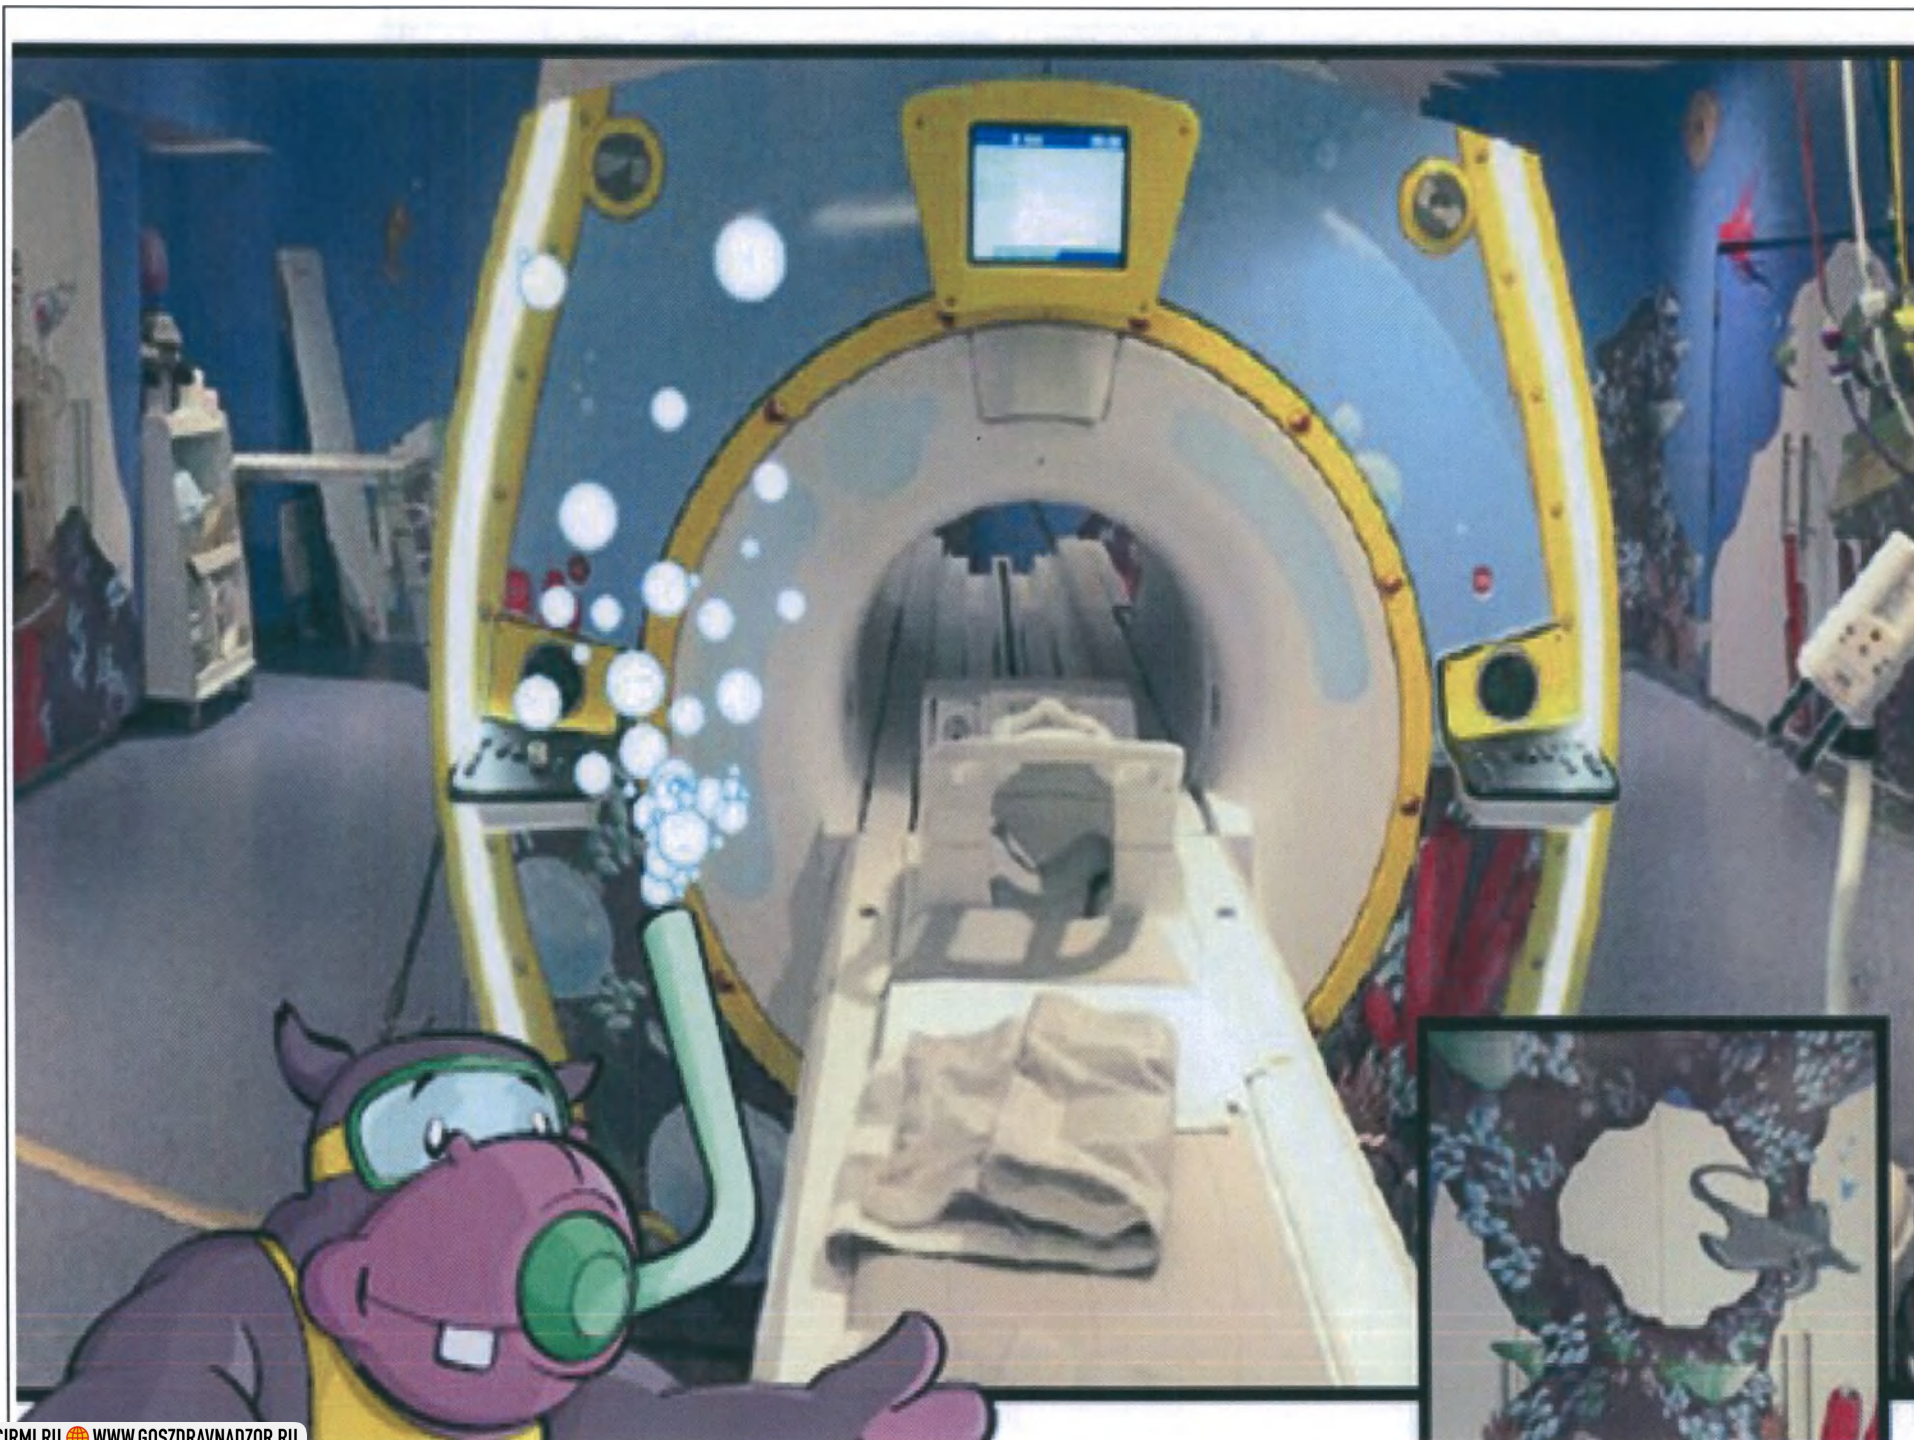

54. Декоративные наклейки



ПРОШУ И
СКРЕПЛЕНО
ПЕЧАТЬЮ 202 Л.



Антонина

