

Фотографии медицинского изделия

«Набор реагентов для определения антигена тяжелого острого респираторного синдрома коронавируса 2 (SARS-CoV-2) в мазке из носоглотки/ ротоглотки человека, на основе коллоидного золота (Colloidal Gold-Based) вариант исполнения 20 тестов», LOT V2022020157A

Производства: Нанкин Вазим Медикал Технолоджи Ко. Лтд / Nanjing Vazyme Medical Technology Co., Ltd

1. Флакон с буферным раствором





Vazyme

**Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2)
Antigen Detection Kit (Colloidal Gold-Based)**

1-Test Cassette

LOT

V2022020157A




2023/08/08




IVD



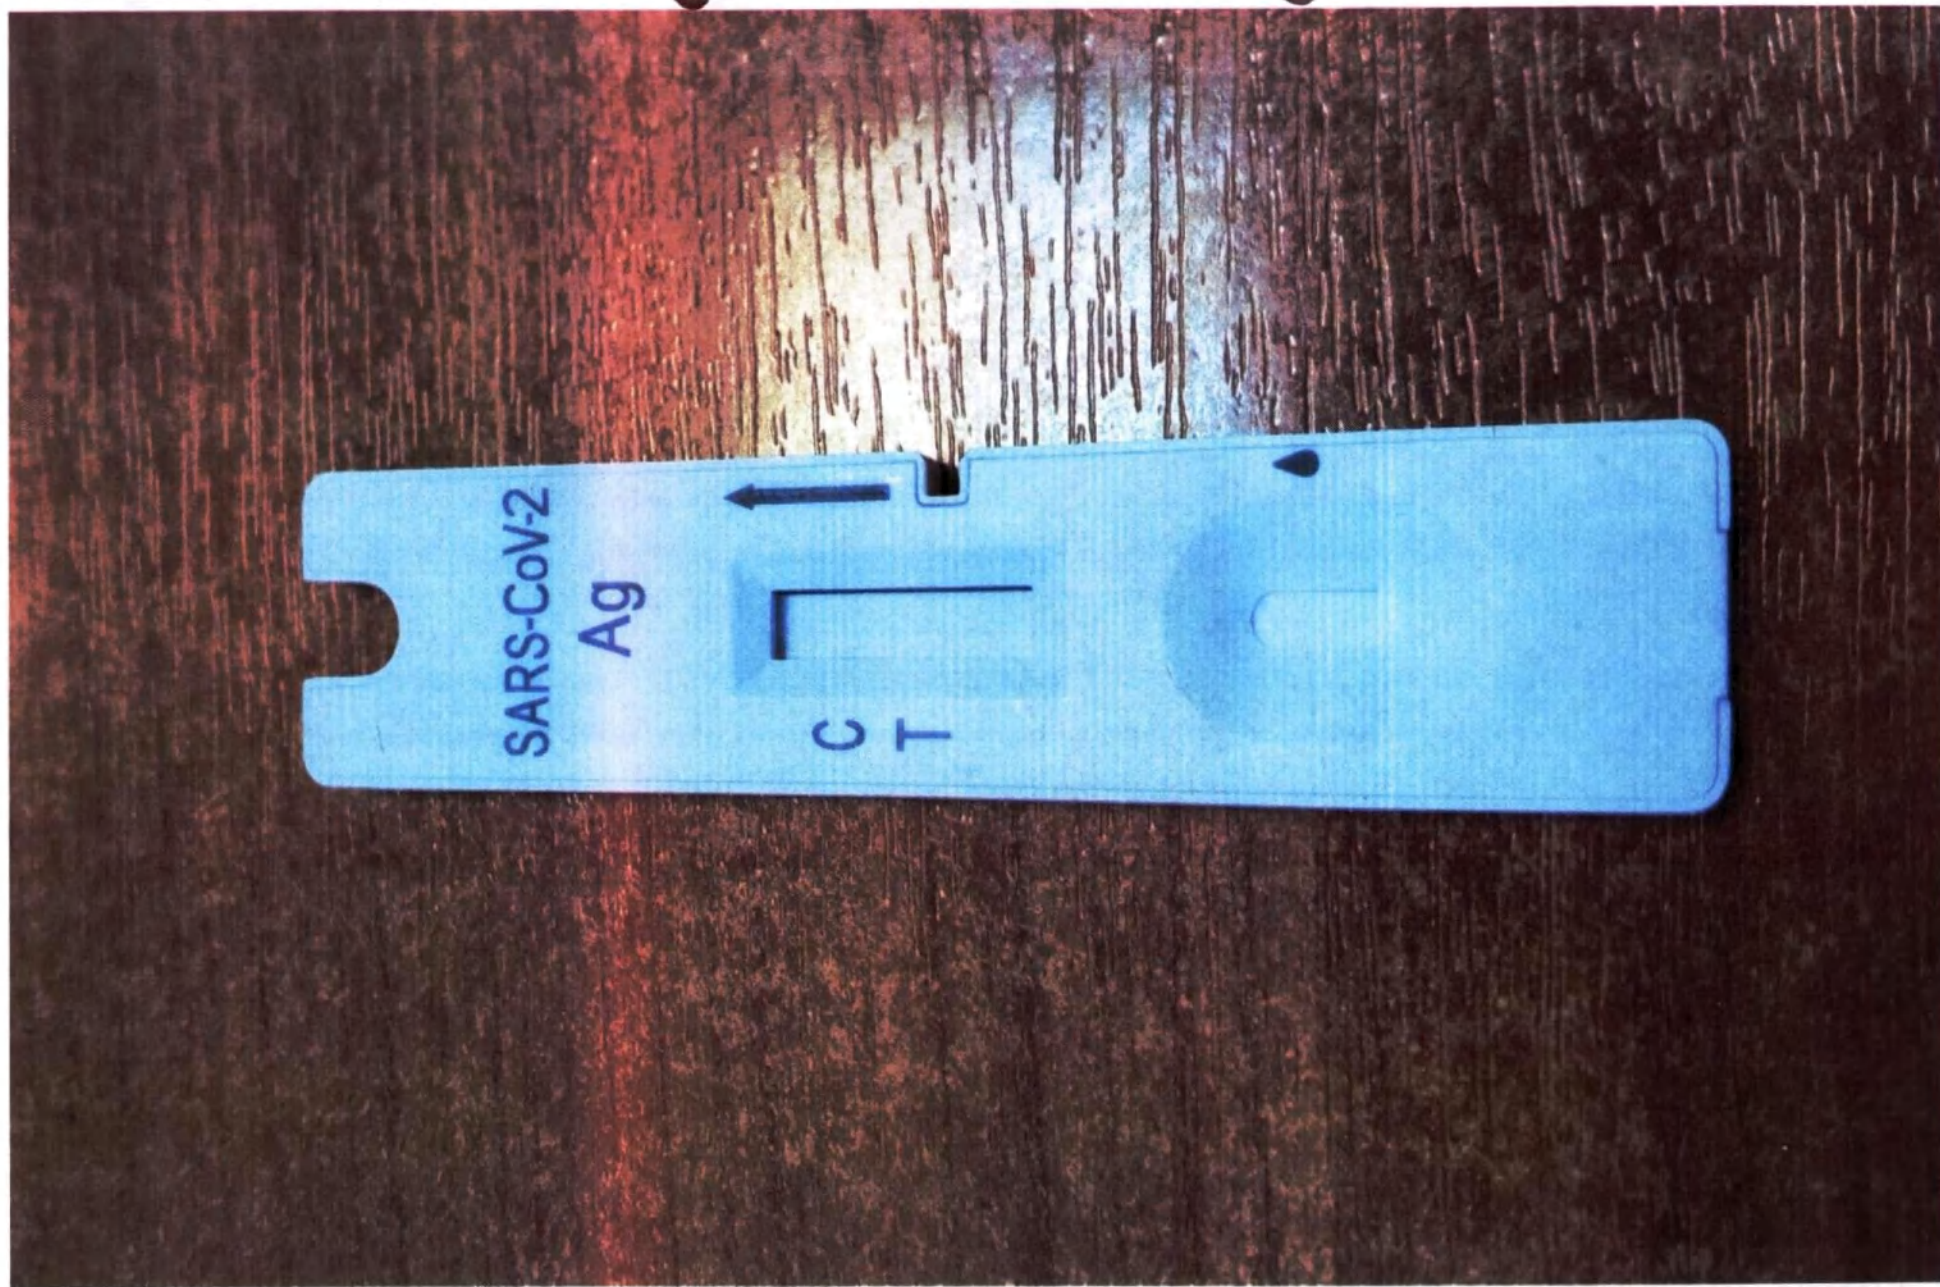

3. Одноразовый тампон для мазка

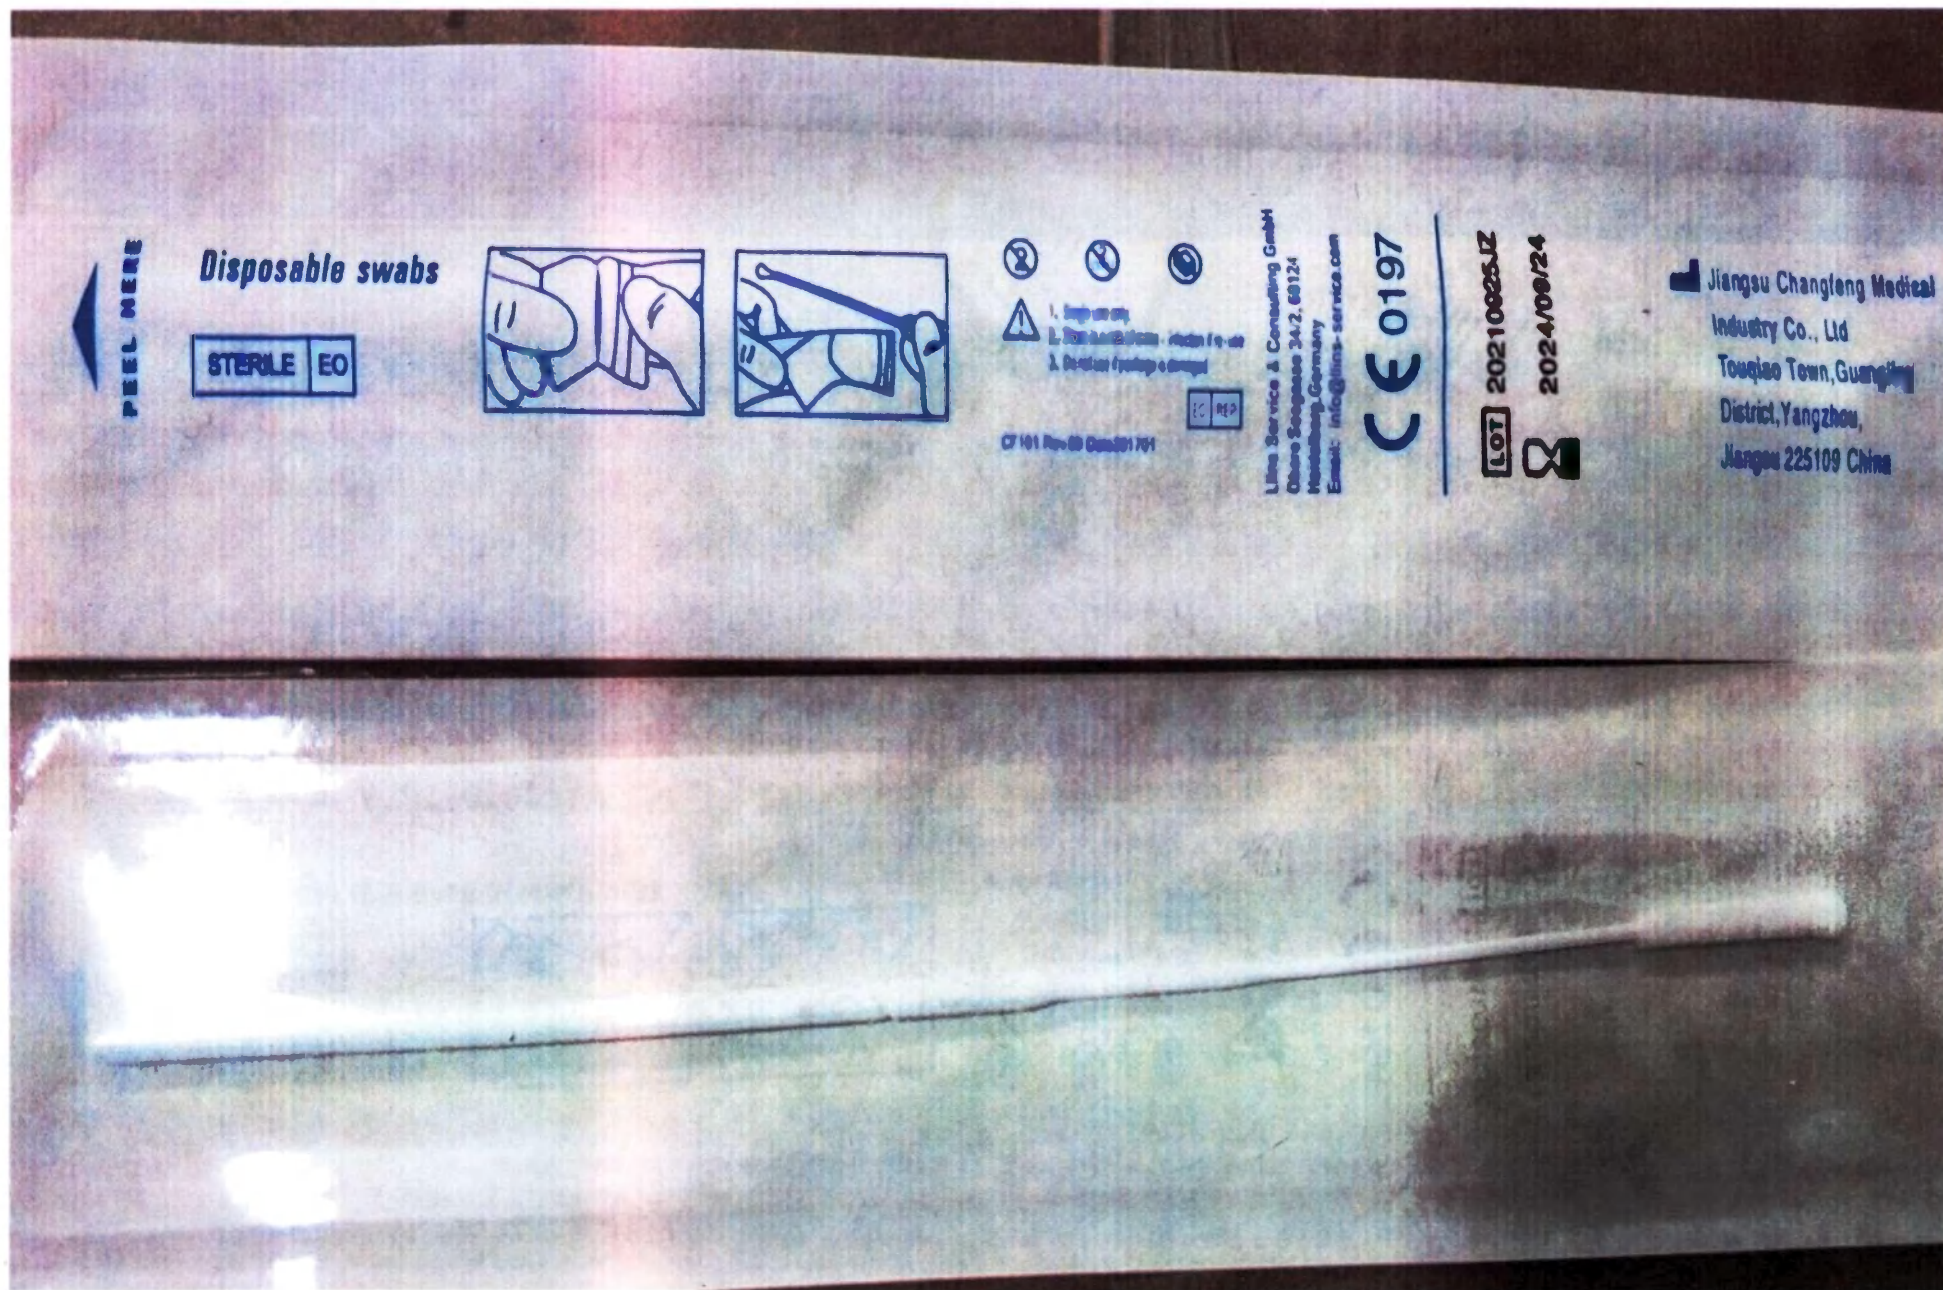

4. Групповая упаковка набора

SARS-CoV-2

 **Vazyme**

«Набор реагентов для определения антигена тяжелого острого респираторного синдрома коронавируса 2 (SARS-CoV-2) в мазке из носоглотки/ротоглотки человека, на основе коллоидного золота (Colloidal Gold-Based) в варианте исполнения 20 тестов».



Состав: 1. Тестовая кассета - 20 шт; 2. Флакон с буферным раствором - 20 шт; 3. Одноразовый тампон для мазка (lot 20210925JZ) - 20 шт. 4. Инструкция по применению - 1 шт.

 20 **LOT** V2022020157A

Регистрационное удостоверение
№
Дата Г.

 2022/02/09
 2023/08/08

Для профессионального применения

  **IVD**     


 Nanjing Vazyme Medical Technology Co. Ltd, 1F-3F,
Building C2, Red Maple Park, of Technological Industry
State Economy & Technology Development Zone 210038
Nanjing, P.R.China / Тел: +86-25-8436-5701

Уполномоченный представитель в РФ: Общество с ограни-
ченной ответственностью «Дируи Медикал» 117246, г.
Москва, Мундипальный округ Черемушки, вн. тор. г. Науч-
ный проезд, д. 17, пом. 5-2, тел: +7(499)9644450, e-mail:
office@dirui.com.ru

ИНСТРУКЦИЯ

по применению медицинского изделия для диагностики in vitro

«Набор реагентов для определения антигена тяжелого острого респираторного
синдрома коронавируса 2 (SARS-CoV-2) в мазке из носоглотки/ротоглотки человека,
на основе коллоидного золота (Colloidal Gold-Based)» в варианте исполнения 20
тестов, LOT V2022020157A.

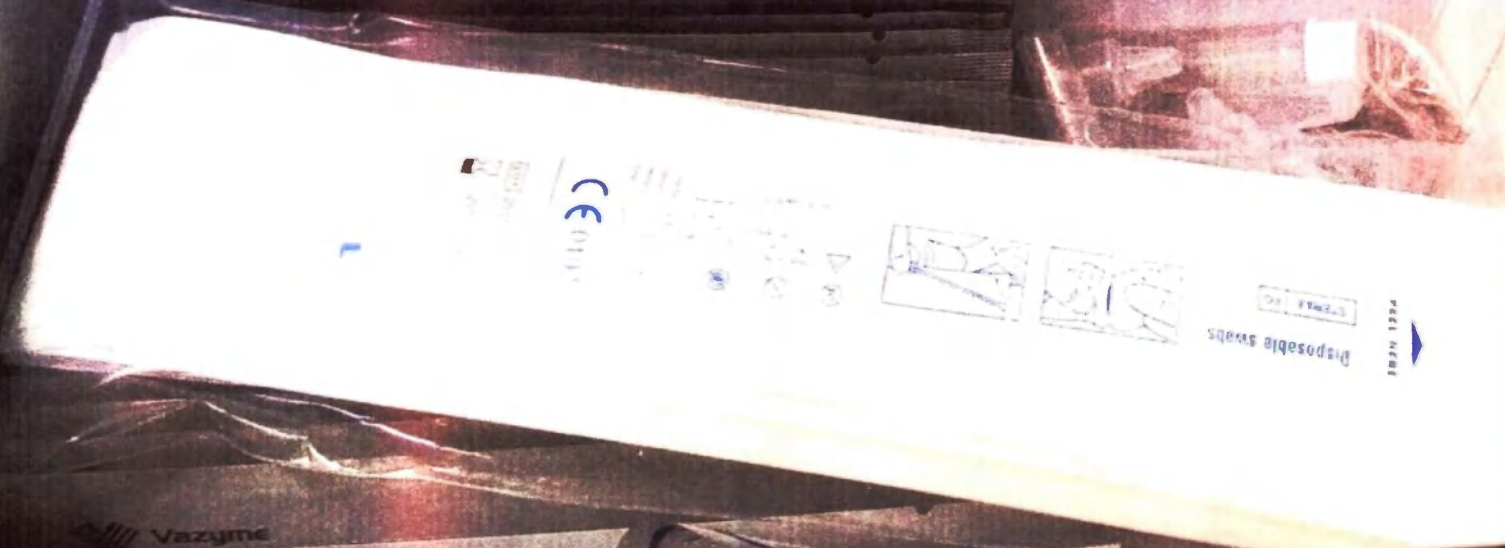

Всего прошито, пронумеровано, скреплено подписью и печатью
Общества 7 (семь) листов.

Генеральный директор
ООО «ДИРУИ МЕДИКАЛ»

