

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
медицинского изделия
«Раствор «ТауроСепт®» для закрытия катетера»,
потребительской первичной, вторичной упаковок и маркировки

1. Раствор для закрытия катетера
«ТауроСепт®», 6 мл

2. Раствор для закрытия катетера
«ТауроСепт®», 10 мл



Рис.1 Раствор «ТауроСепт®» для закрытия катетера, варианты исполнения:

1. Раствор для закрытия катетера «ТауроСепт®», 6 мл;
2. Раствор для закрытия катетера «ТауроСепт®», 10 мл.

Потребительская первичная упаковка

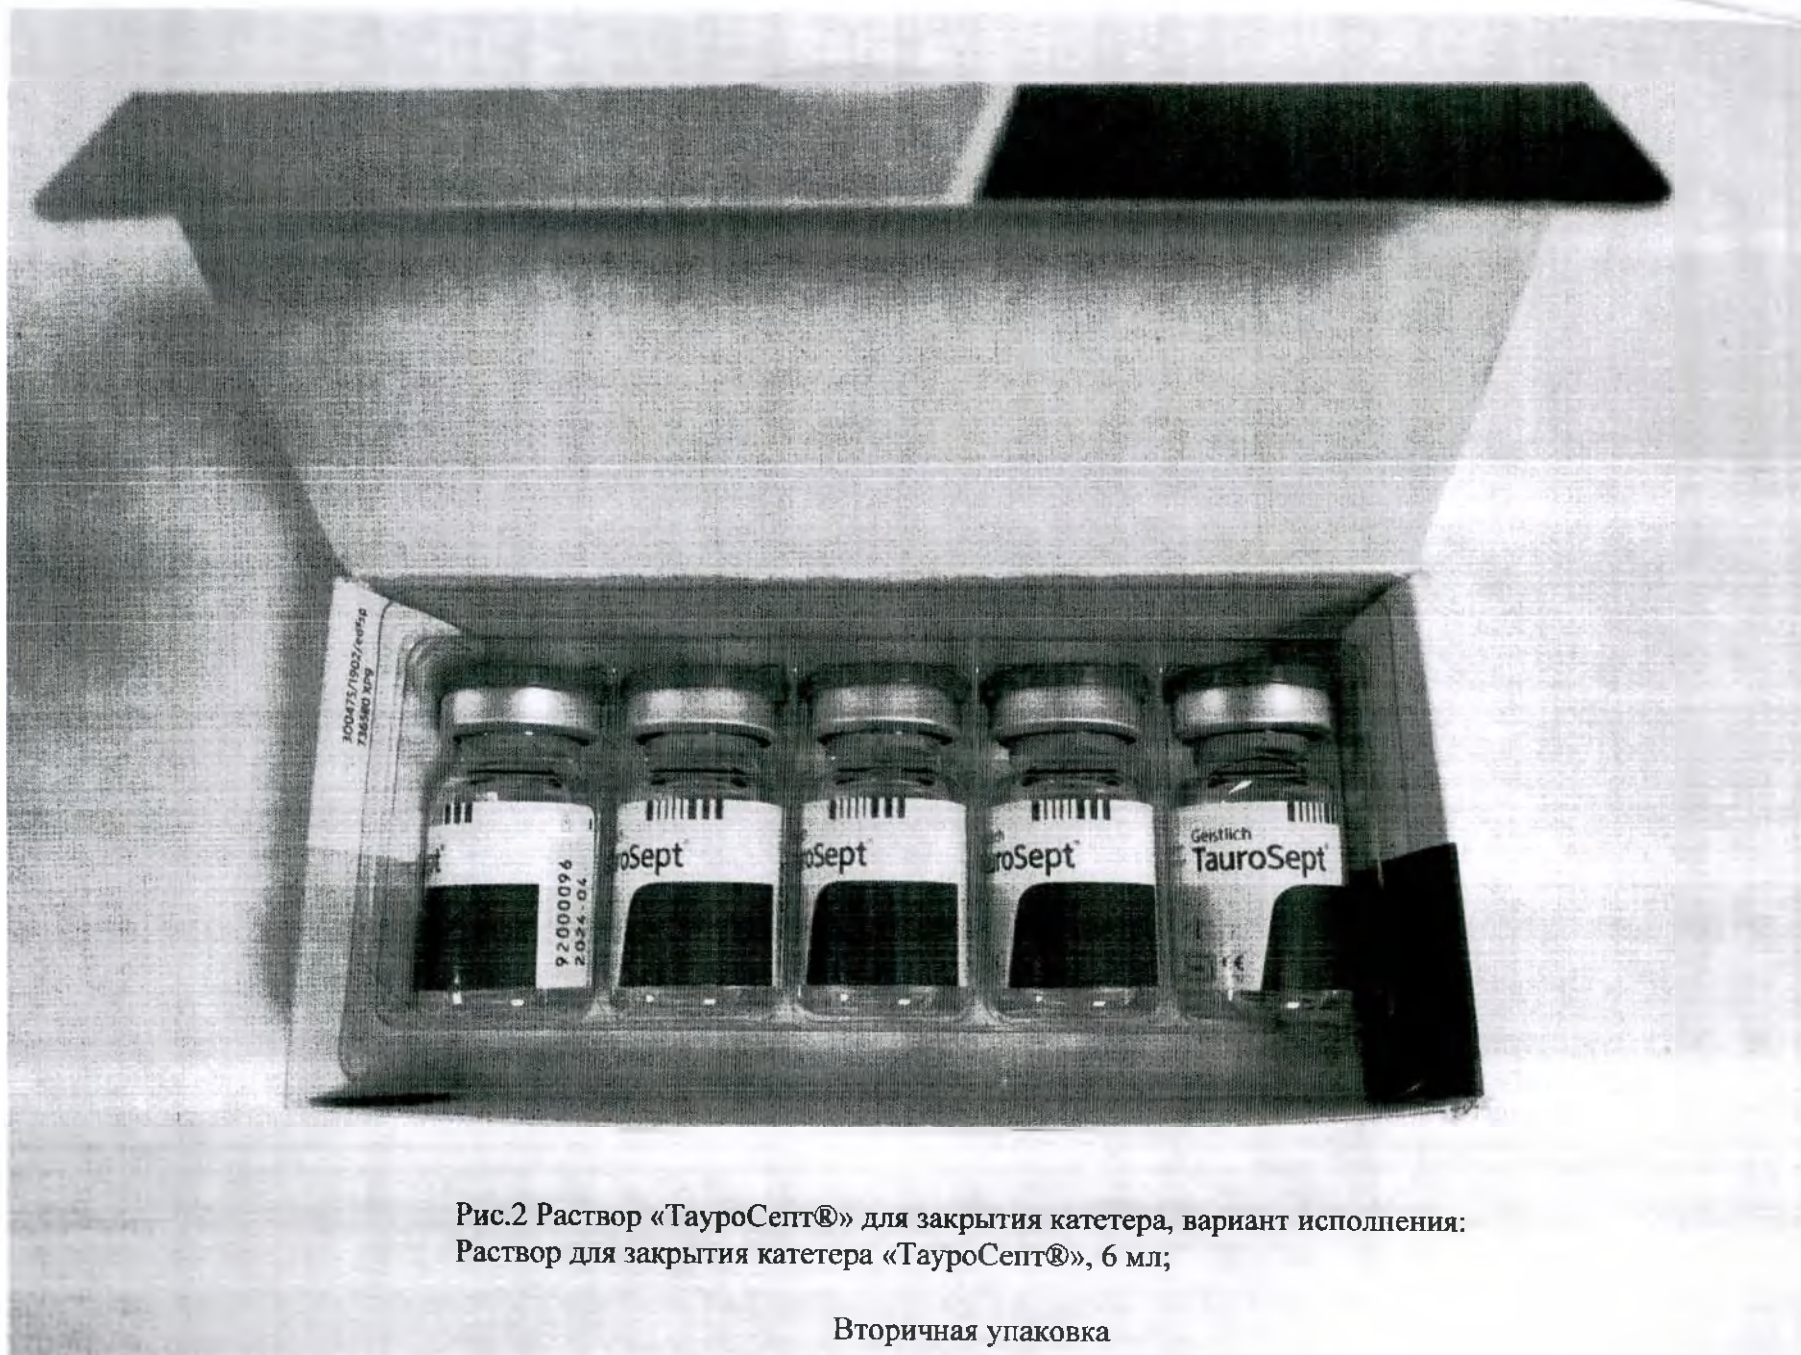


Рис.2 Раствор «ТауроСепт®» для закрытия катетера, вариант исполнения:
Раствор для закрытия катетера «ТауроСепт®», 6 мл;

Вторичная упаковка

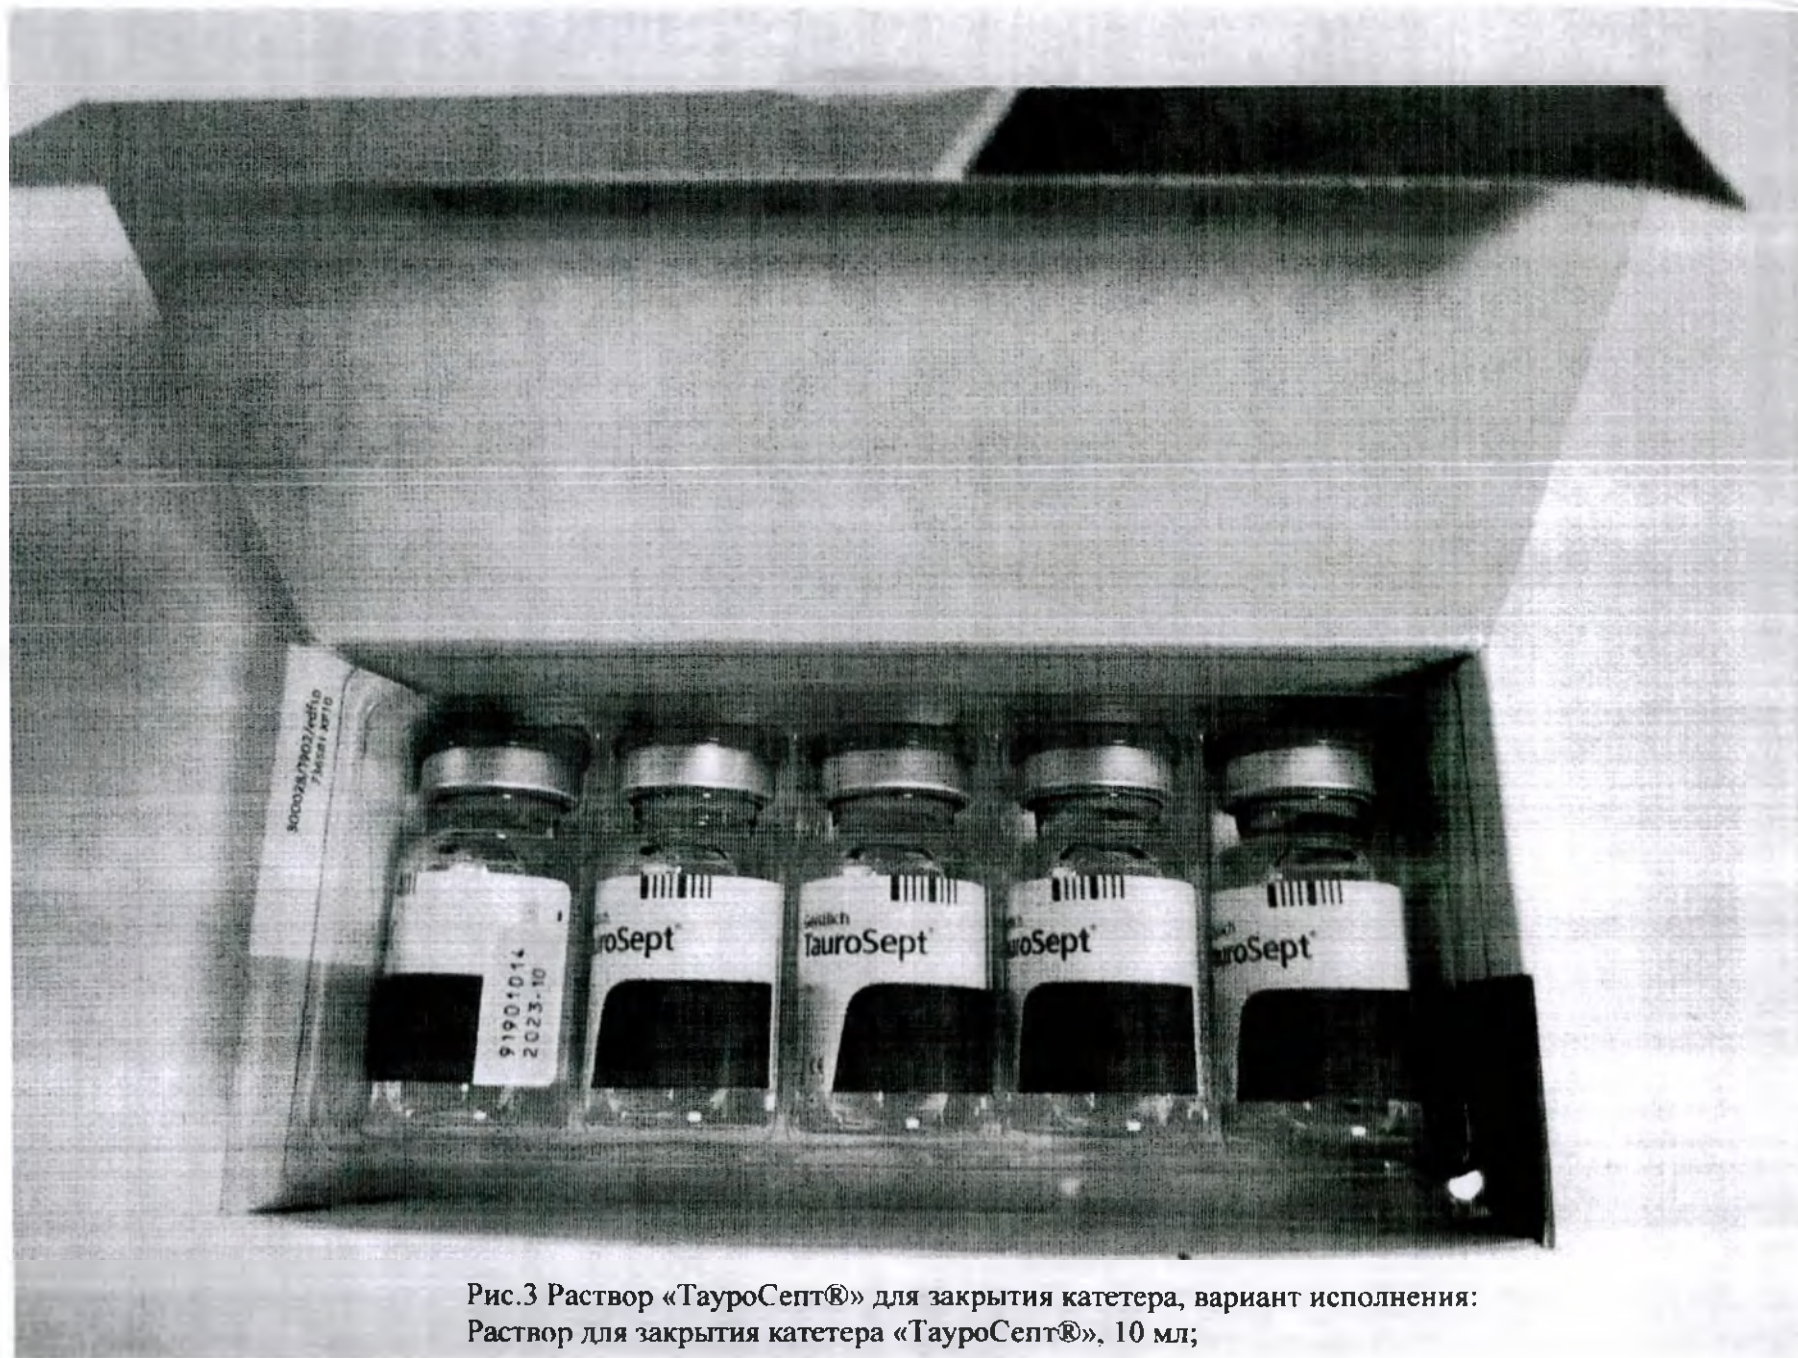


Рис.3 Раствор «ТауроСепт®» для закрытия катетера, вариант исполнения:
Раствор для закрытия катетера «ТауроСепт®», 10 мл;

Вторичная упаковка

**Раствор «ТауроСепт®» для закрытия катетера, 6 мл
СТЕРИЛЬНО!**

Назначение: предназначен для инстилляции в устройства сосудистого доступа в периоды между процедурами, с целью предотвращения роста патогенной микрофлоры, поддержания проходимости устройств сосудистого доступа. **Показания:** «ТауроСепт®» является раствором для закрытия катетера и применяется для пациентов с установленными устройствами сосудистого доступа при рисках окклюзии, закупорки, бактериальной или грибковой инфекции устройств сосудистого доступа. **Противопоказания:** индивидуальная непереносимость веществ, входящих в состав раствора, одновременное лечение препаратами, обладающими побочным эффектом при взаимодействии с тауролидином. **Побочные эффекты:** в редких случаях возможны аллергические реакции. При возникновении аллергической реакции немедленно прекратить использование раствора. **Предупреждения:** ОСТОРОЖНО! Раствор необходимо ввести в устройство доступа так, как описано в инструкции по применению. Несоблюдение требований инструкции может привести к случайной системной инъекции раствора тауролидина. **Меры предосторожности:** Раствор для однократного применения в качестве расходного материала. Не предназначен для системных инъекций. Не смешивать с окислителями такими как раствор Дакина (пилюхлорит натрия), Повидон-йод или перекись водорода из-за окисления до муравьиной кислоты. Не используйте изделия по истечении срока годности. Хранить и транспортировать в горизонтальном положении при контролируемой температуре от 15 до 25 °C и относительной влажности не более 80%. Не замораживать!

Состав: Тауролидин 2%, Поливинилпирролидон 5% (ПВП-17); вода для инъекций, следы гидроксида натрия для регуляции pH до 7,3.

«Геистлик Фарма AG» (Geistlich Pharma AG), (Bahnhofstrasse 40, 8110 Wetzhausen), Швейцария.

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ по вопросам полного обращения медицинских изделий: ООО «ТМ», Россия, 197022, г. СПб, улица Профессора Полова, дом 23, литер К, помещение 41, тел. +7(812)4027740, e-mail: info@tm.ru, RU № _____ от _____
Использованные изделия обеззараживаются и утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 (класс Б).
Неиспользованные изделия утилизировать как отходы класса А.

5 флаконов




Geistlich
Pharma

PO 01000000
«Geistlich AG, 8110 Wetzhausen»



PZN -09508763



10221070015 >

Рис.4 Раствор «ТауроСепт®» для закрытия катетера, вариант исполнения:
Раствор для закрытия катетера «ТауроСепт®», 6 мл;

Маркировка вторичной упаковки

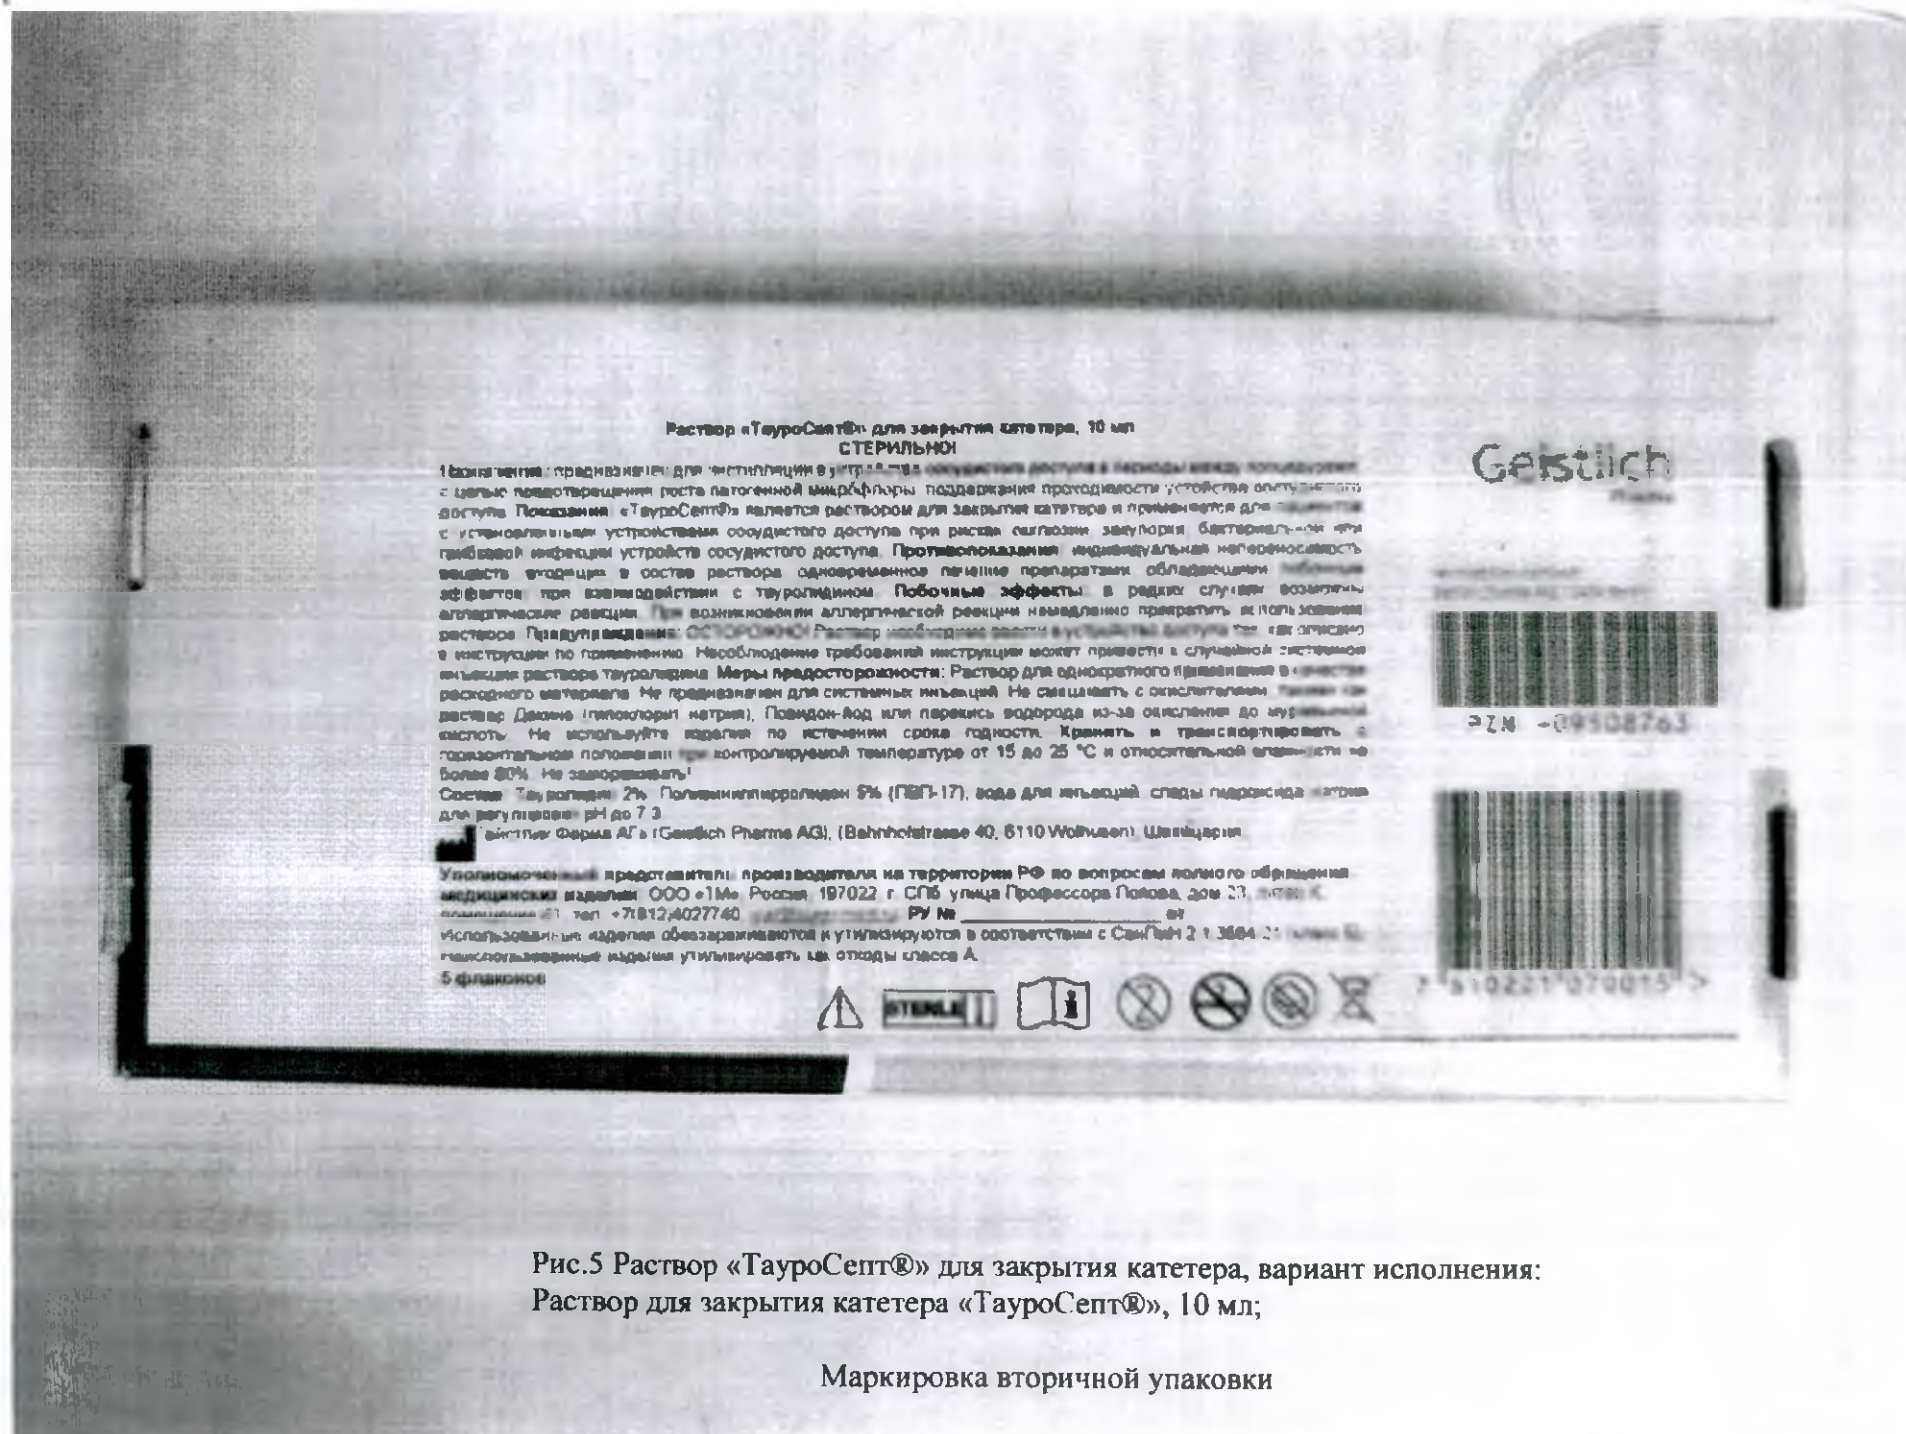


Рис.5 Раствор «ТауроСепт®» для закрытия катетера, вариант исполнения:
Раствор для закрытия катетера «ТауроСепт®», 10 мл;

Маркировка вторичной упаковки

Прошито и пронумеровано .

61 шесть

Генеральный директор

000

