

Утверждаю
Генеральный директор
ООО «БиоВитрум»



О. А. Зиновьев

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Набор реагентов для *in vitro* диагностики наличия мутаций гена EGFR
методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени в
образцах плазмы крови человека, 48 реакций

Наименование медицинского изделия

Набор реагентов для in vitro диагностики наличия мутаций гена EGFR методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени в образцах плазмы крови человека, 48 реакций, в составе:

1. Реакционная смесь 1 для определения мутации цоДНК (2X) Для реакции 1, 1 пробирка
 2. Реакционная смесь 2 для определения мутации СТ (2X) Для реакций 2-7, 4 пробирки
 3. Смесь праймеров / проб, 7 пробирок
 4. Смесь положительного контроля (ПК), 1 пробирка
 5. Краткая инструкция (при необходимости)
-

Фото 1. Реакционная смесь 1 для определения мутации по ДНК (2X) Для реакции 1 (вид спереди)



Фото 2. Реакционная смесь 1 для определения мутации по ДНК (2X) Для реакции 1 (вид сверху)

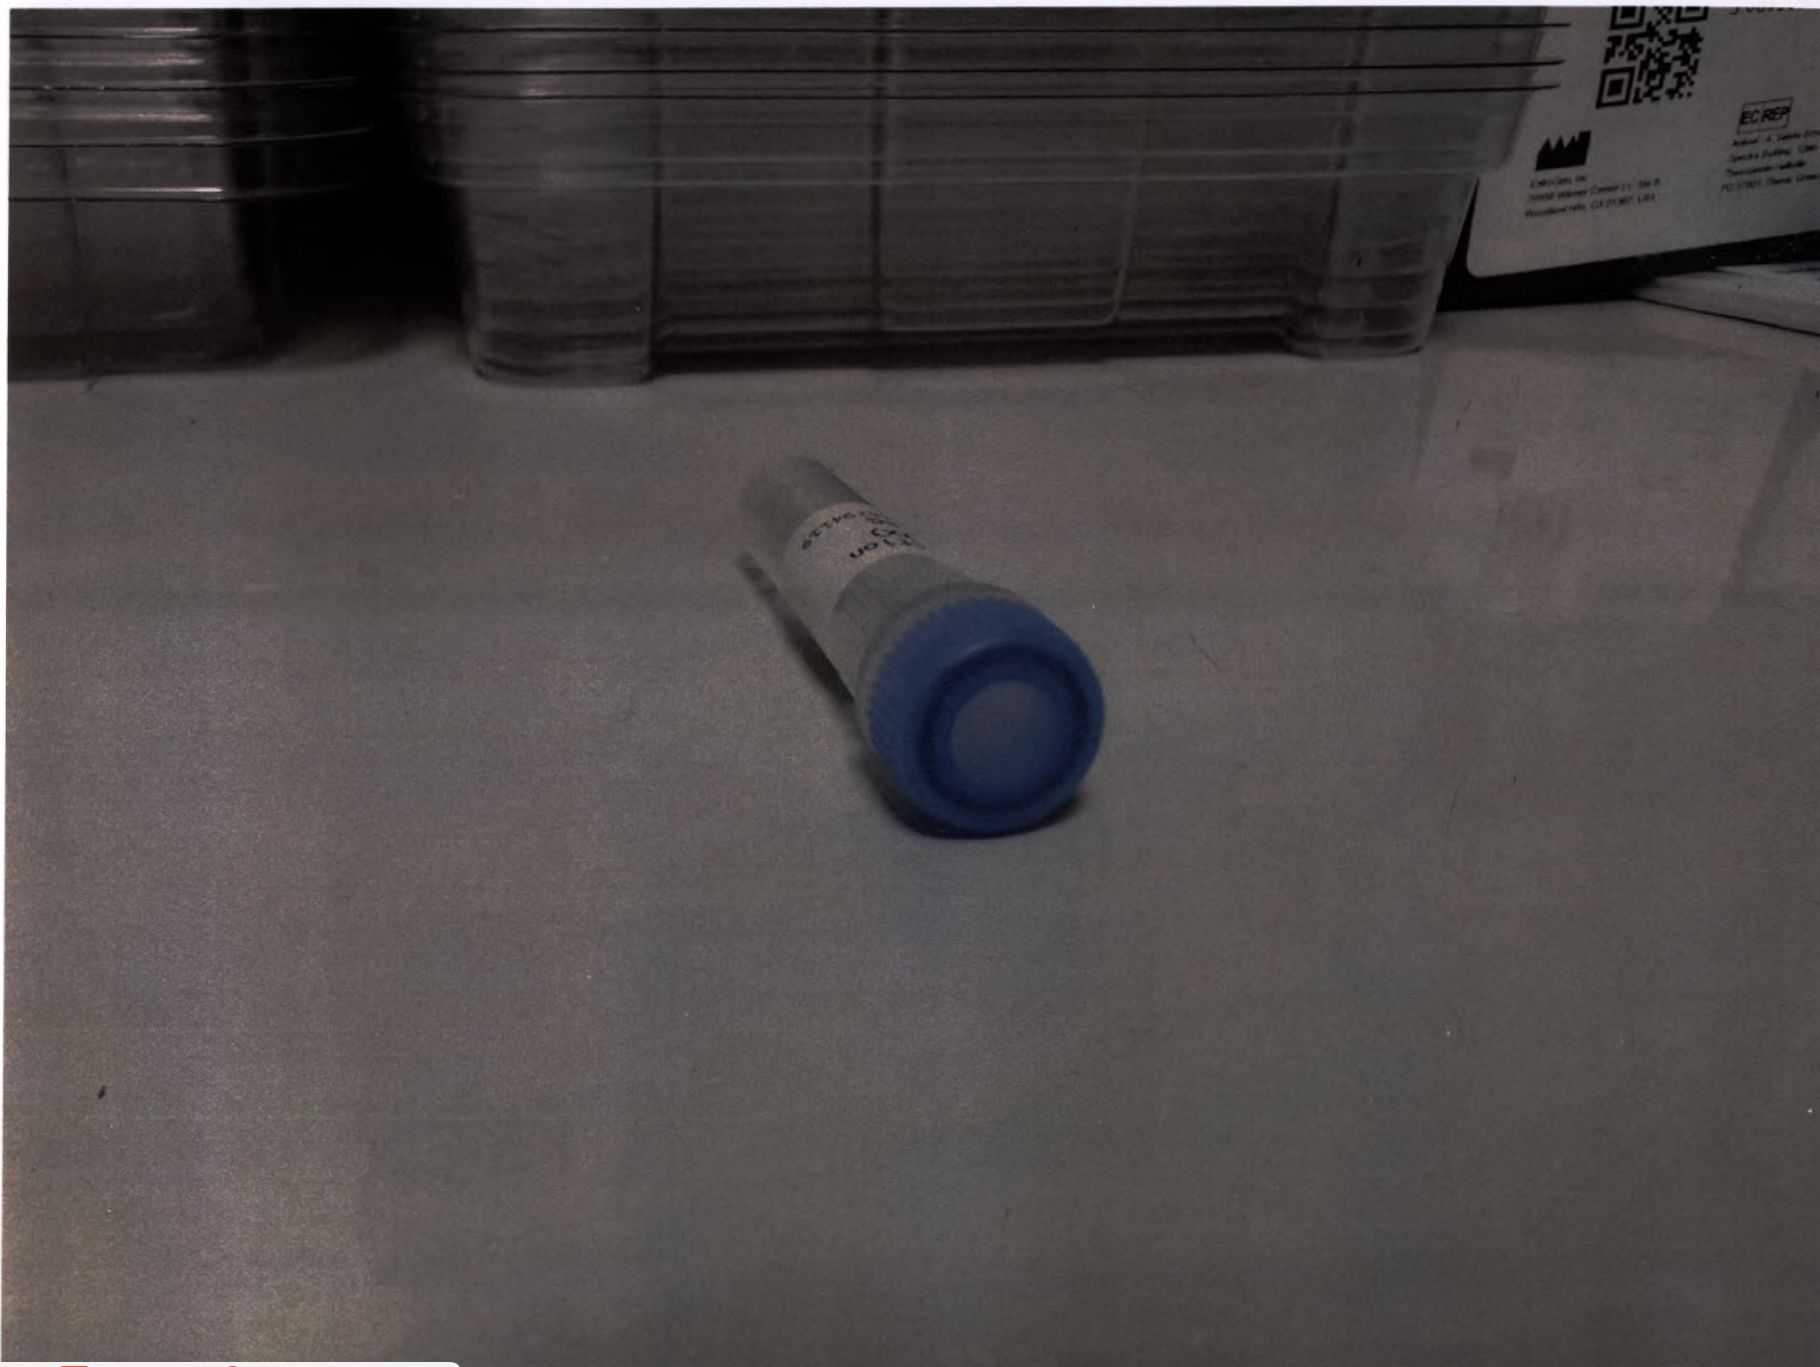


Фото 3. Реакционная смесь 2 для определения мутации СТ (2X) Для реакций 2-7 (вид спереди)

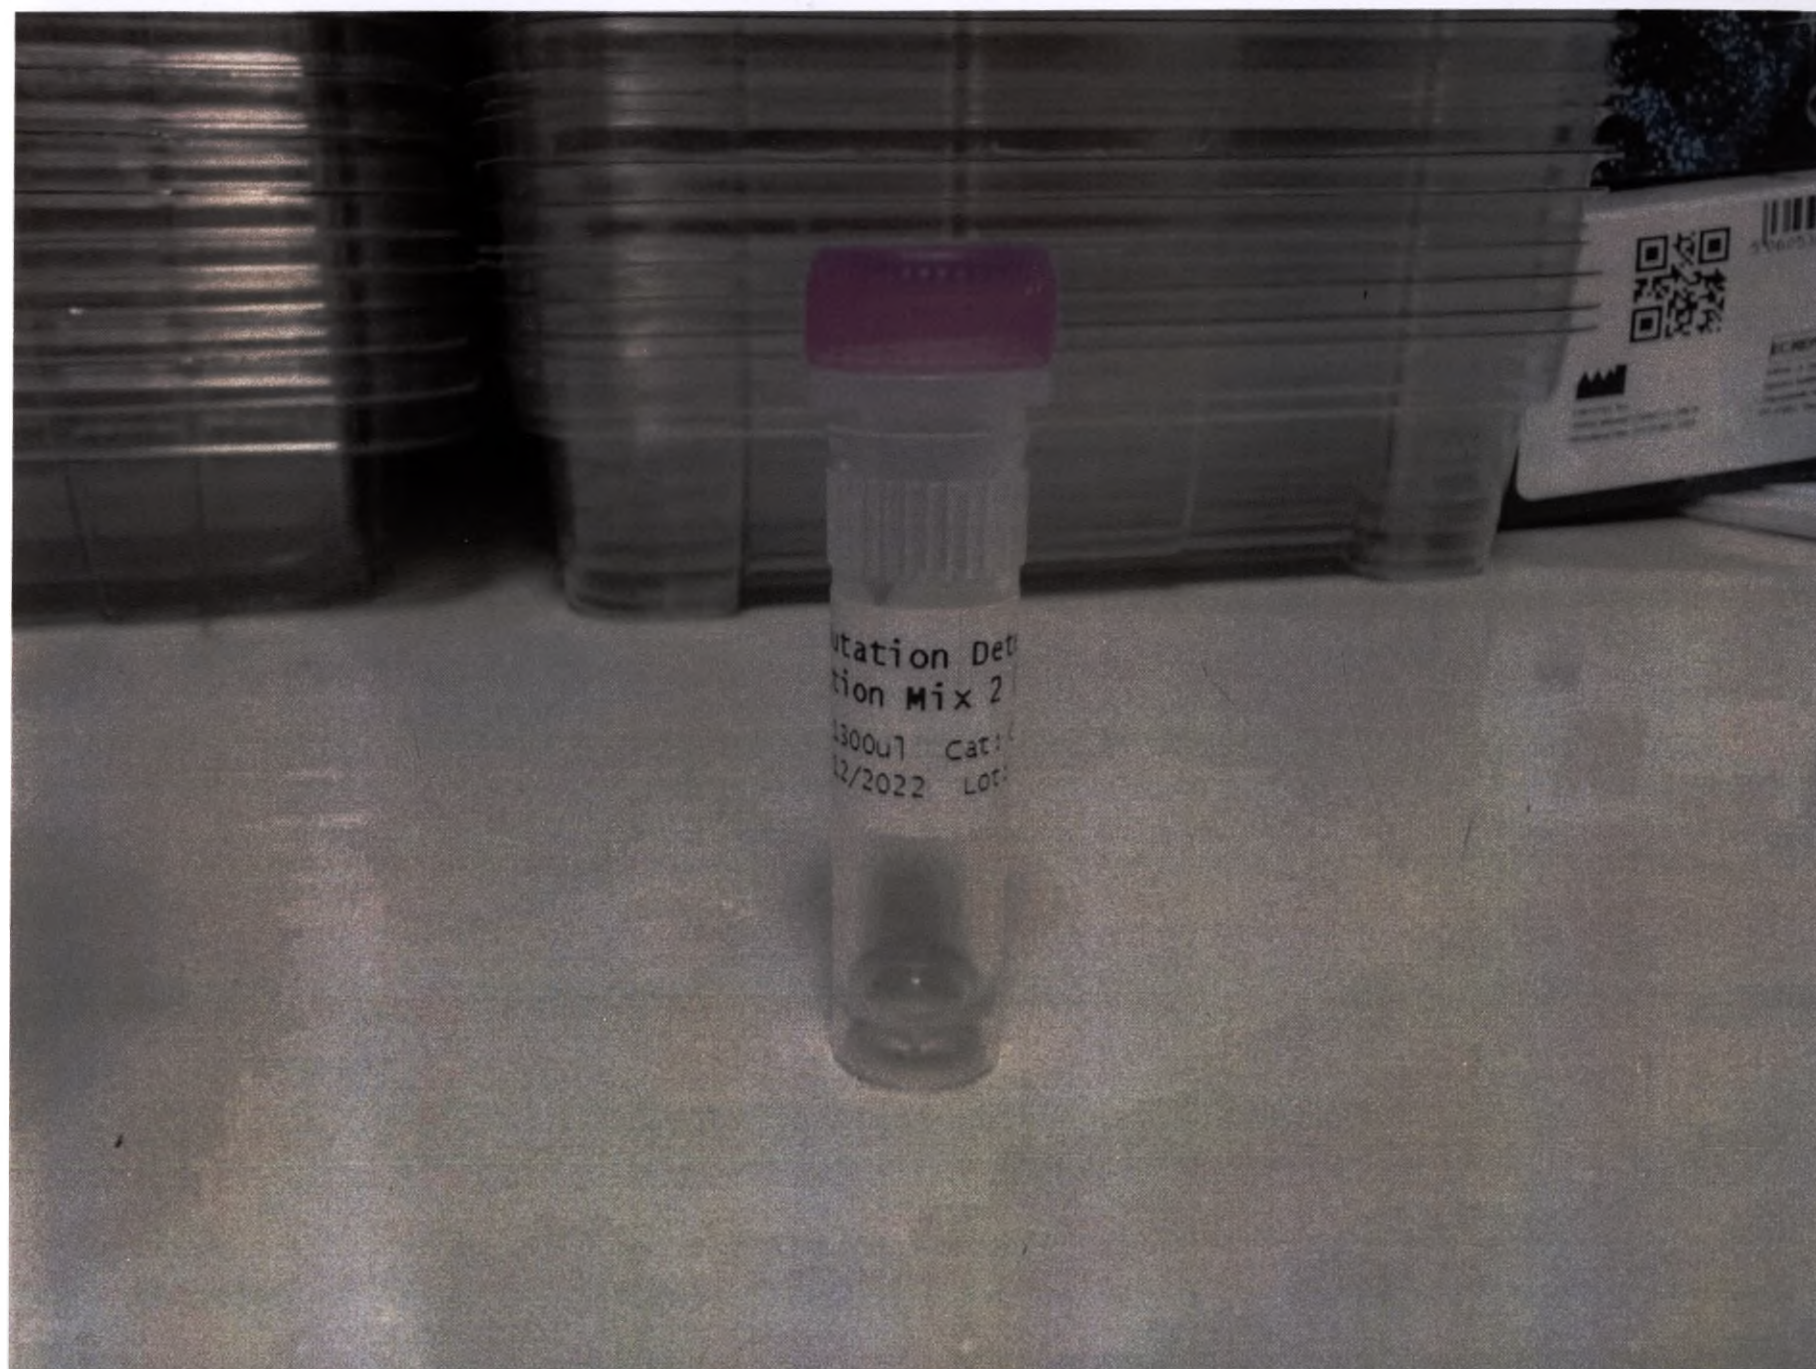


Фото 4. Реакционная смесь 2 для определения мутации СТ (2X) Для реакций 2-7 (вид сверху)

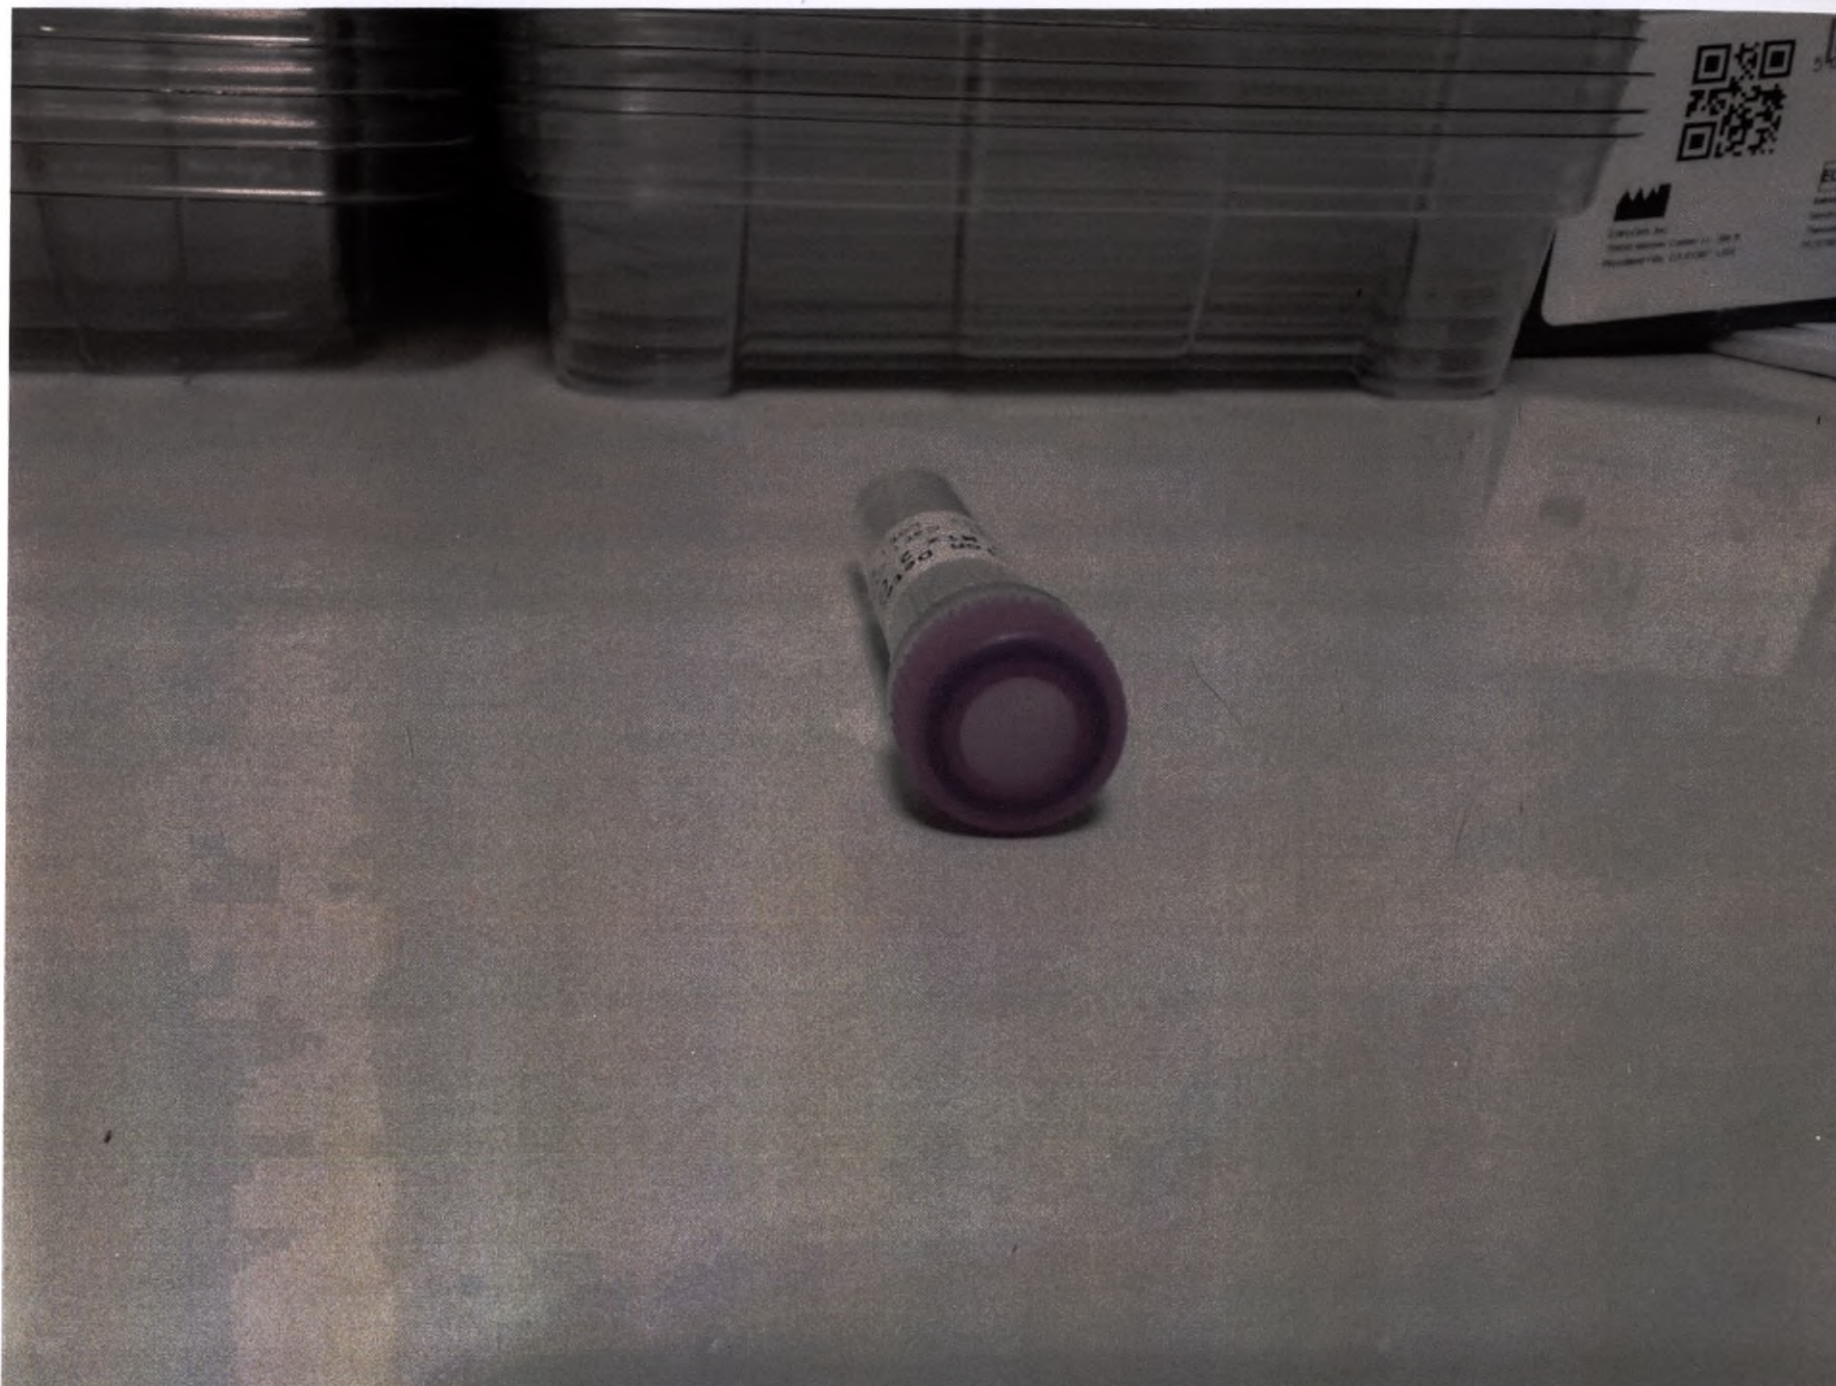


Фото 5. Смесь праймеров / проб. 1я пробирка (вид спереди)

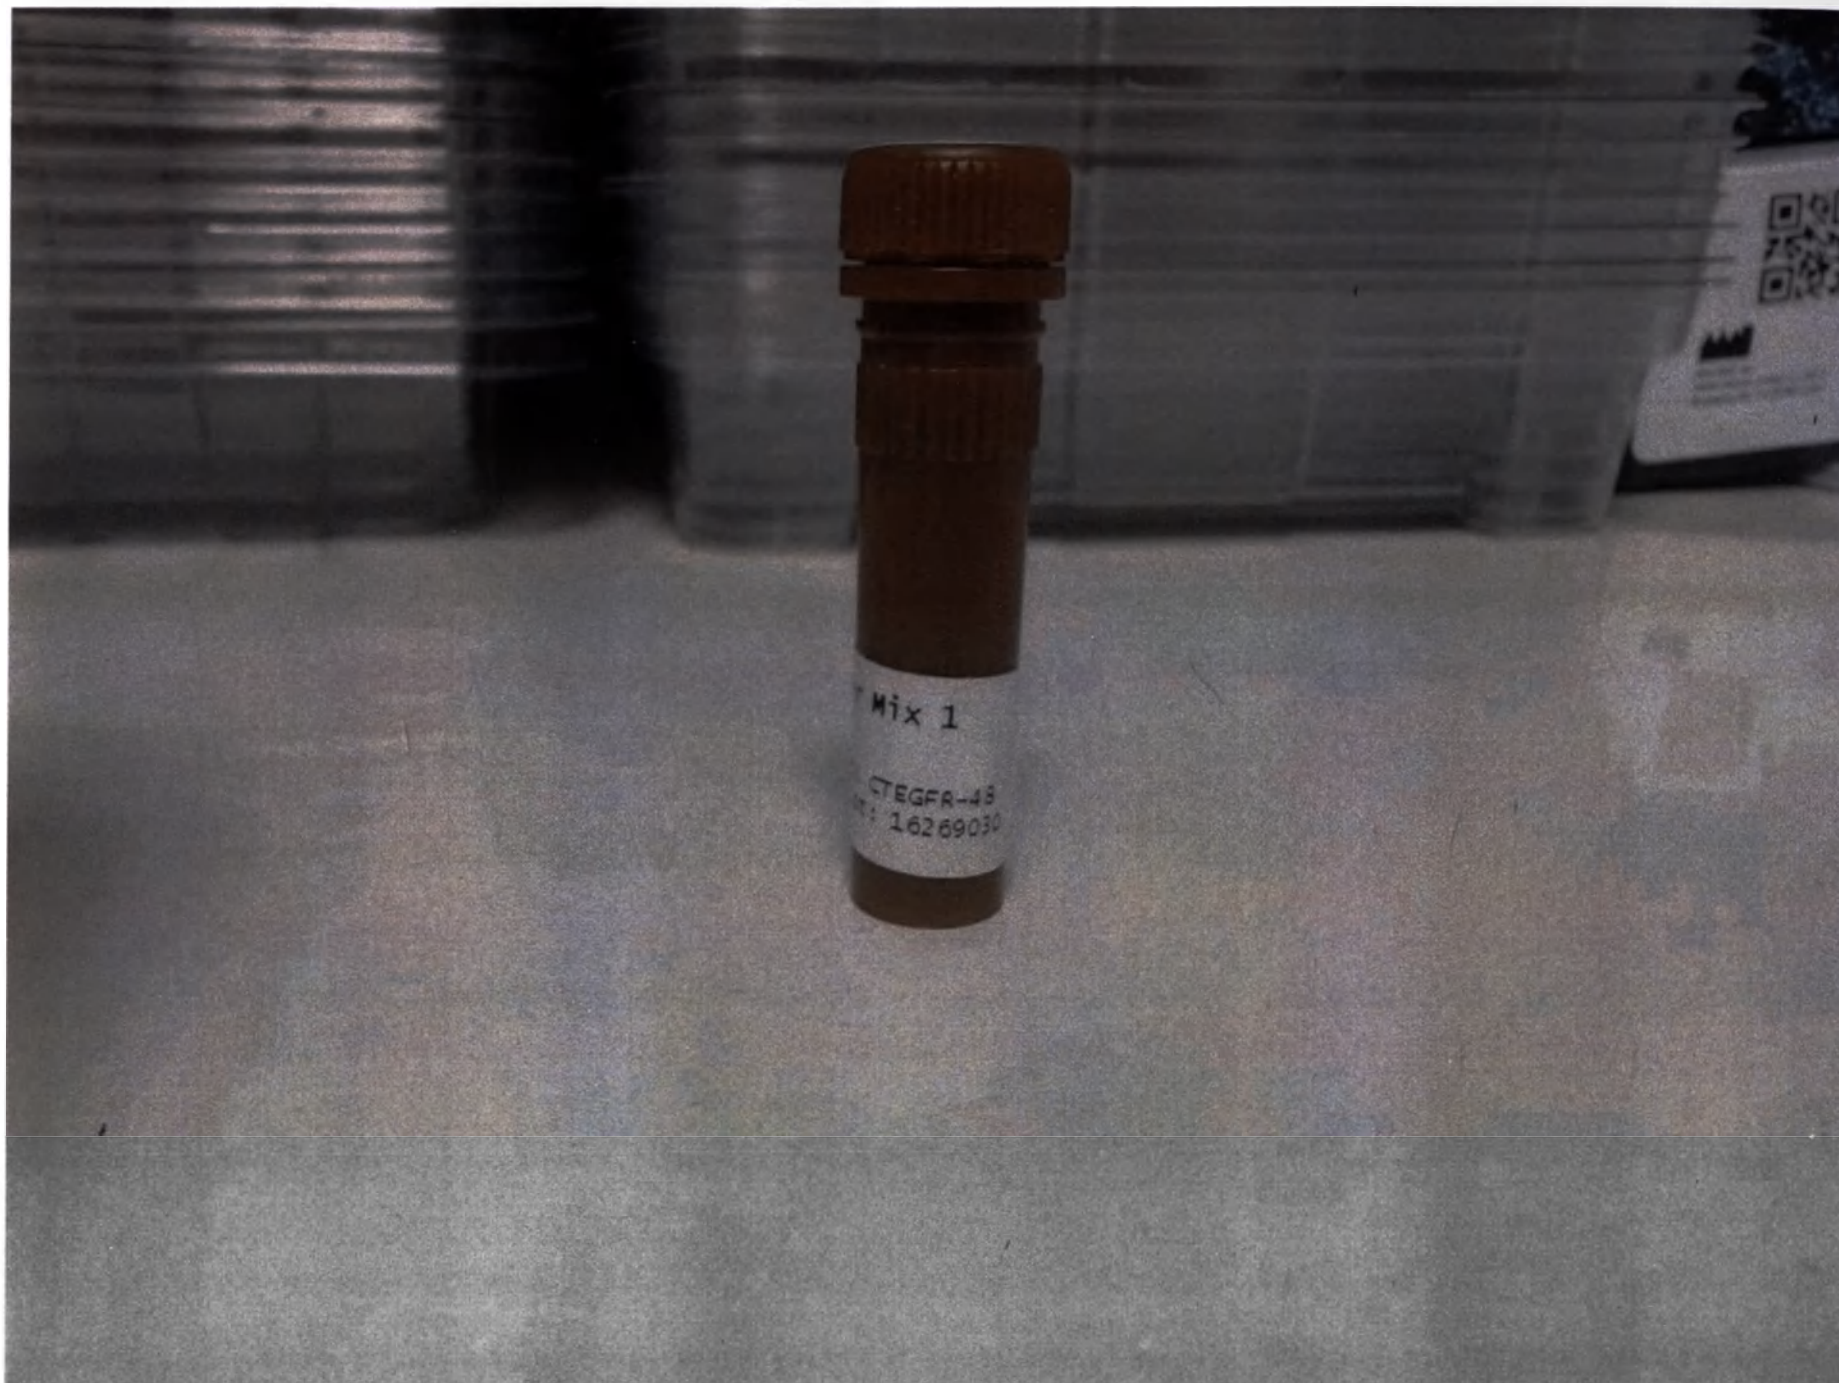


Фото 6. Смесь праймеров / проб. 1я пробирка (вид сверху)

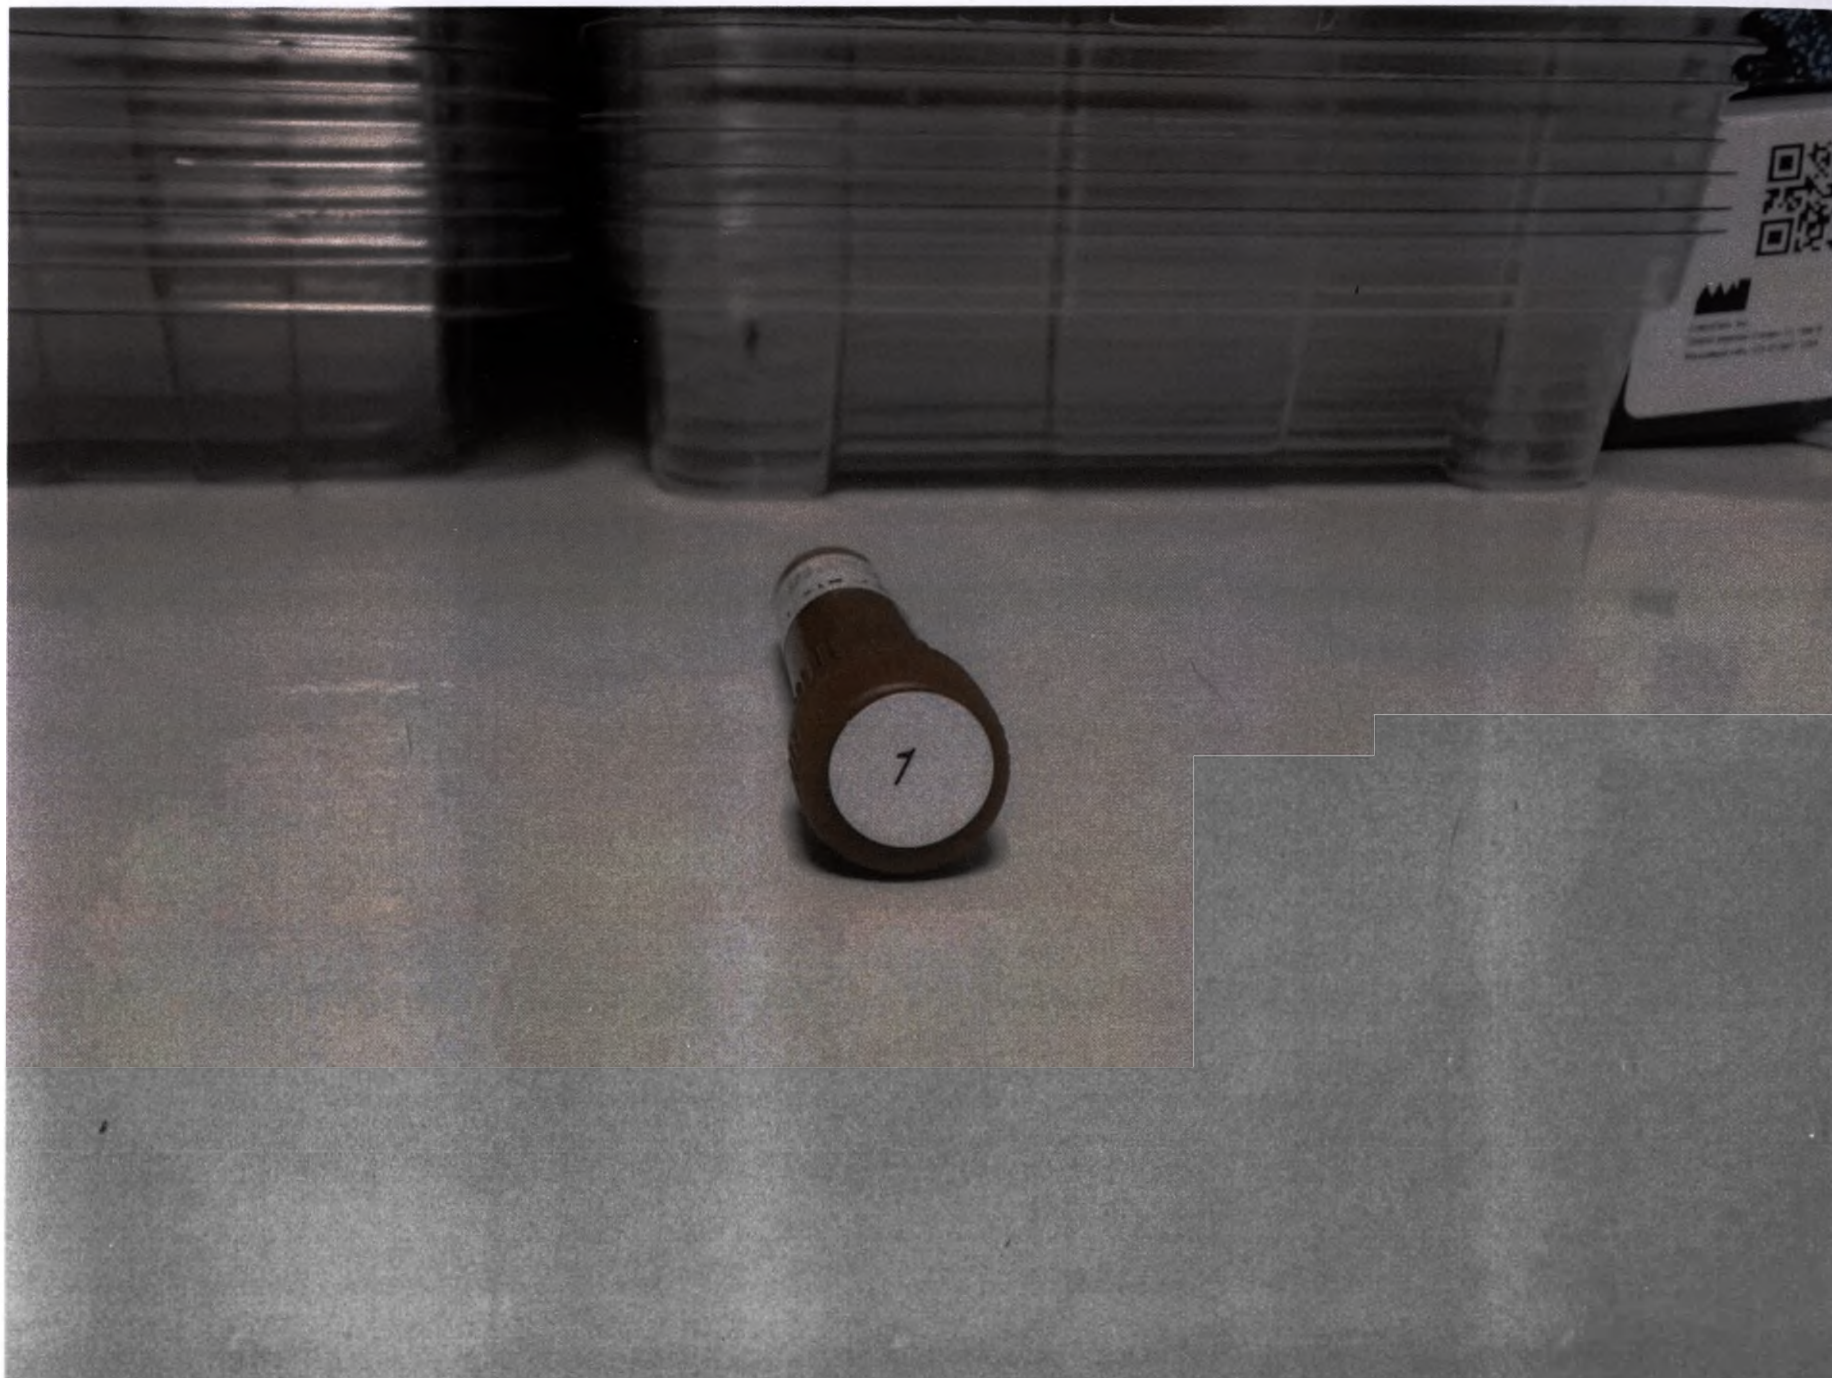


Фото 7. Смесь праймеров / проб, 2я пробирка (вид спереди)

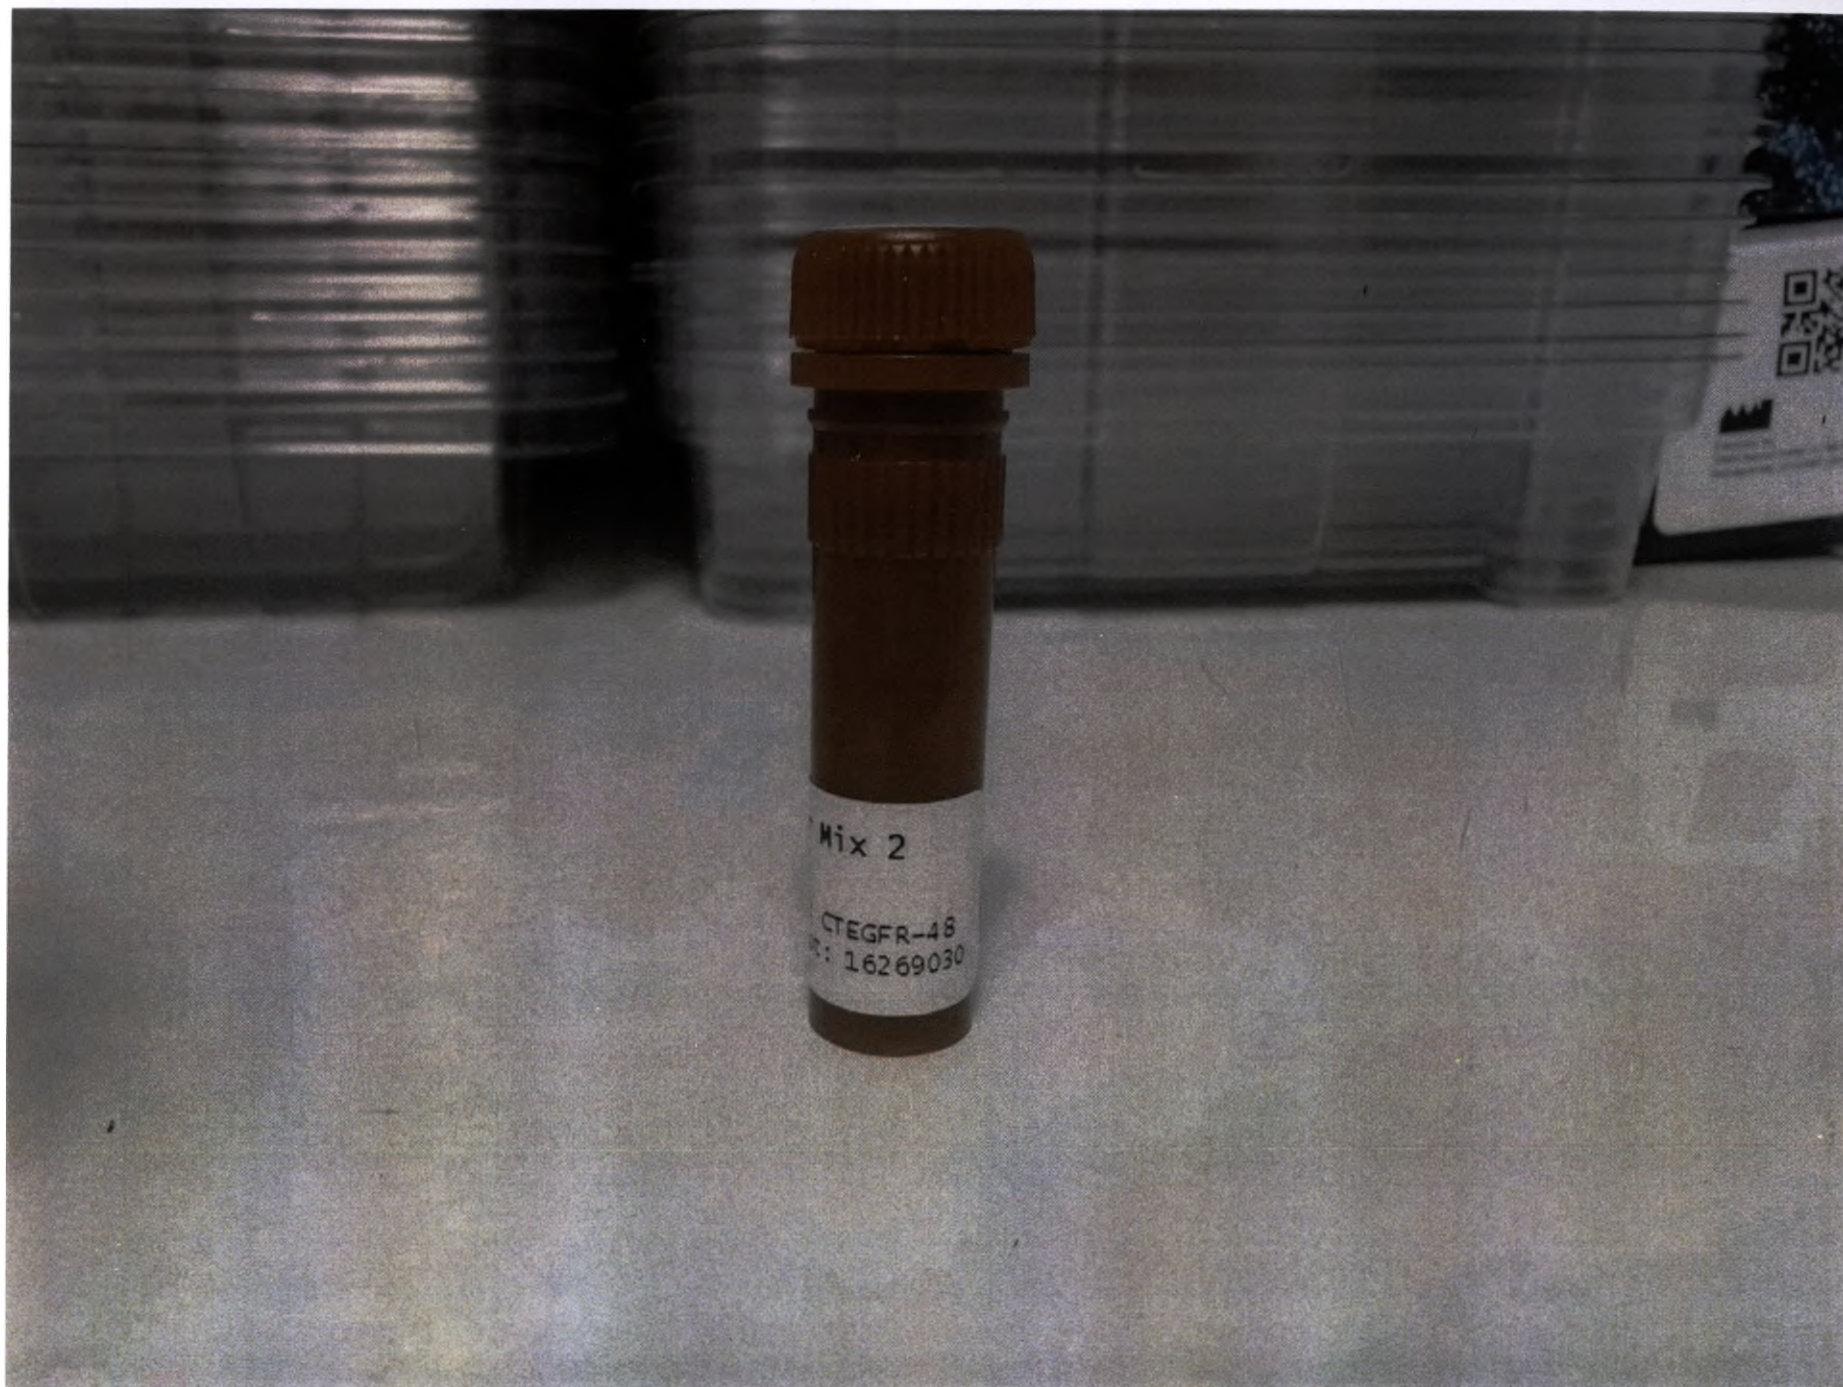


Фото 8. Смесь праймеров / проб, 2я пробирка (вид сверху)

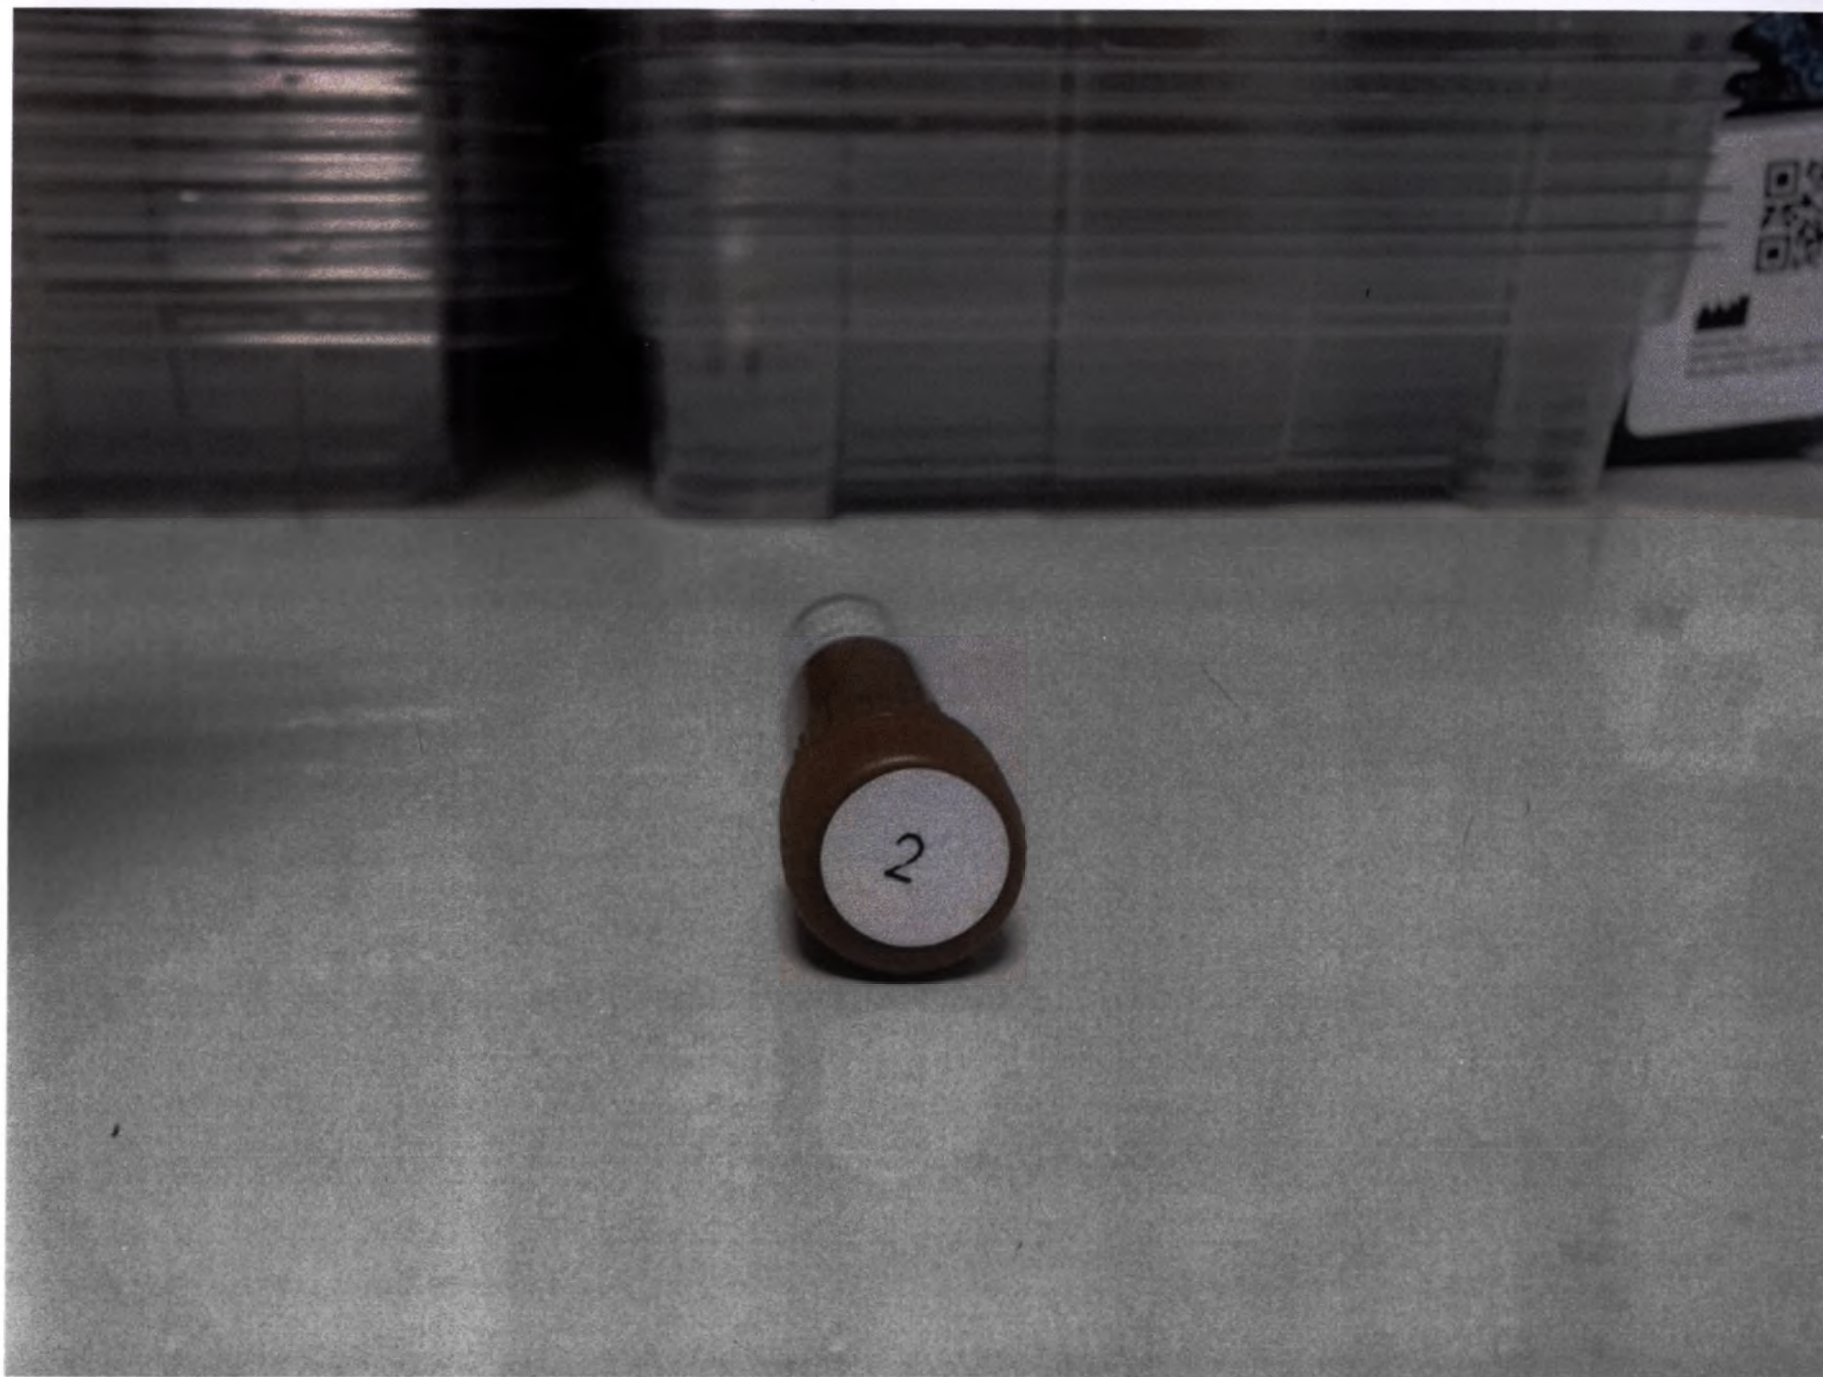


Фото 9. Смесь праймеров / проб, 3я пробирка (вид спереди)

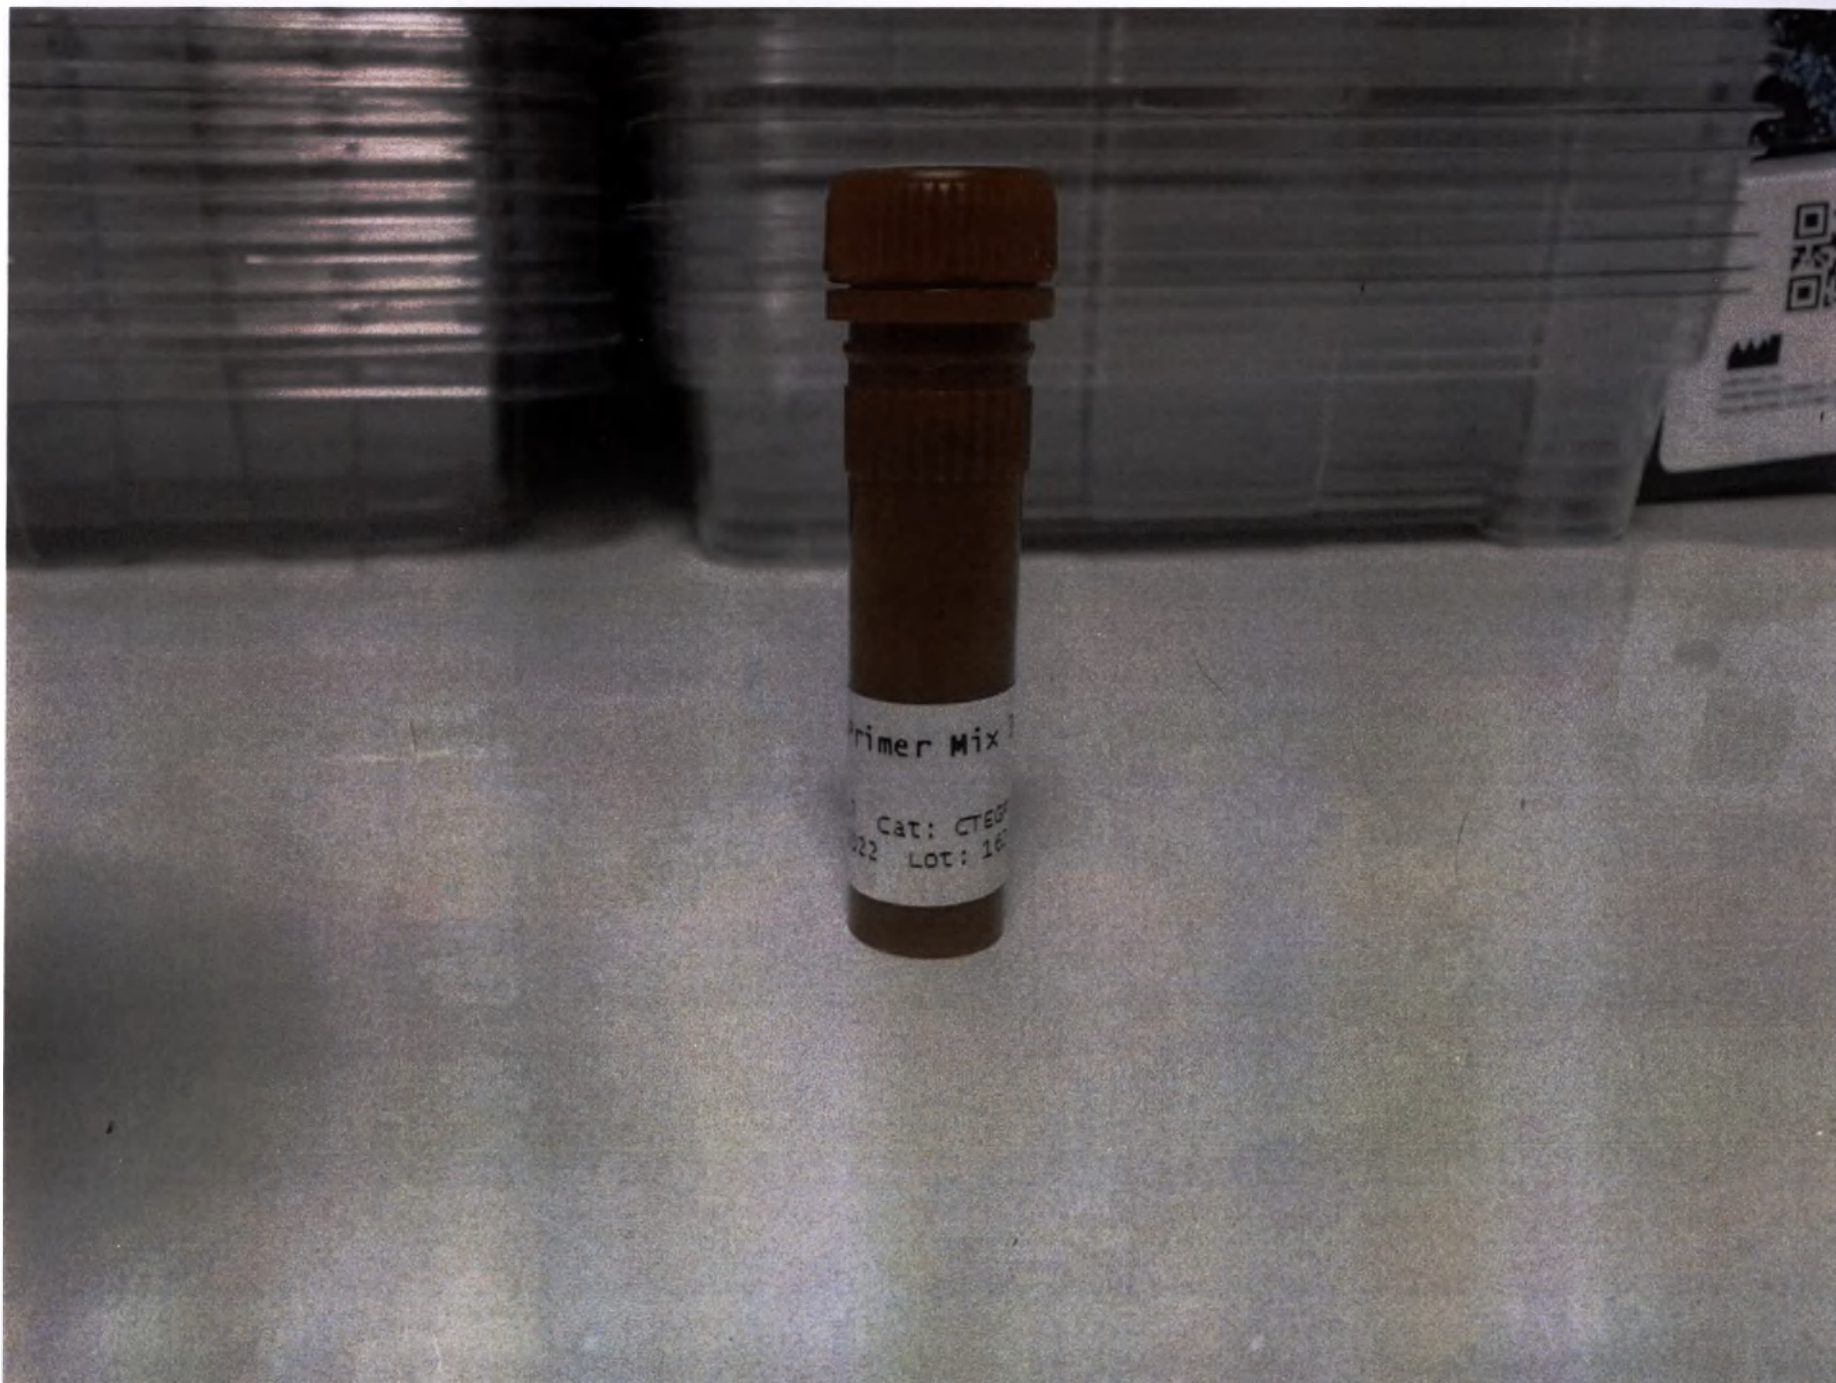


Фото 19. Смесь праймеров / проб. 3я пробирка (вид сверху)

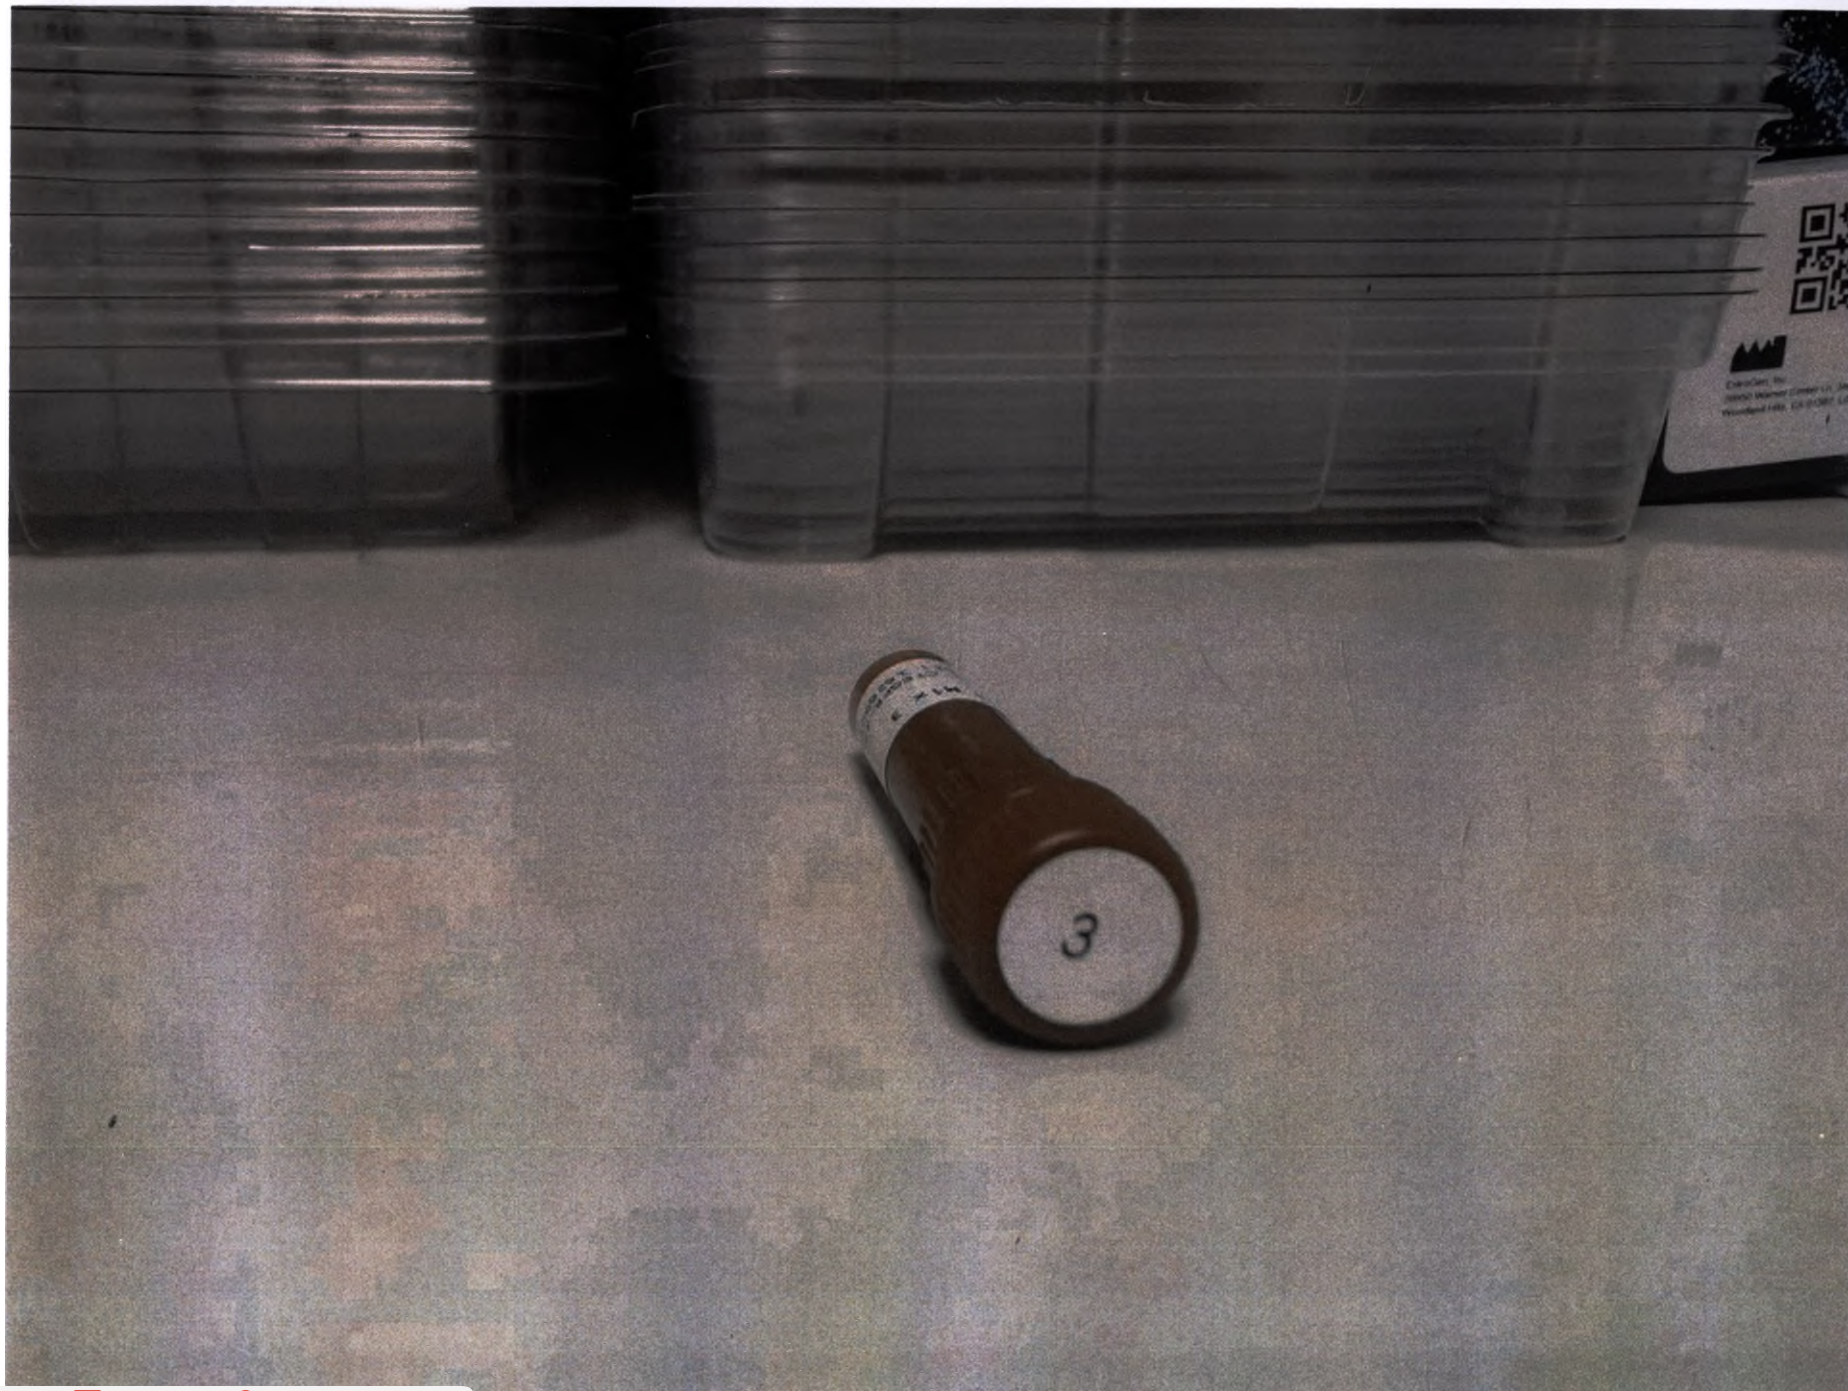


Фото 11. Смесь праймеров / проб, 4я пробирка (вид спереди)

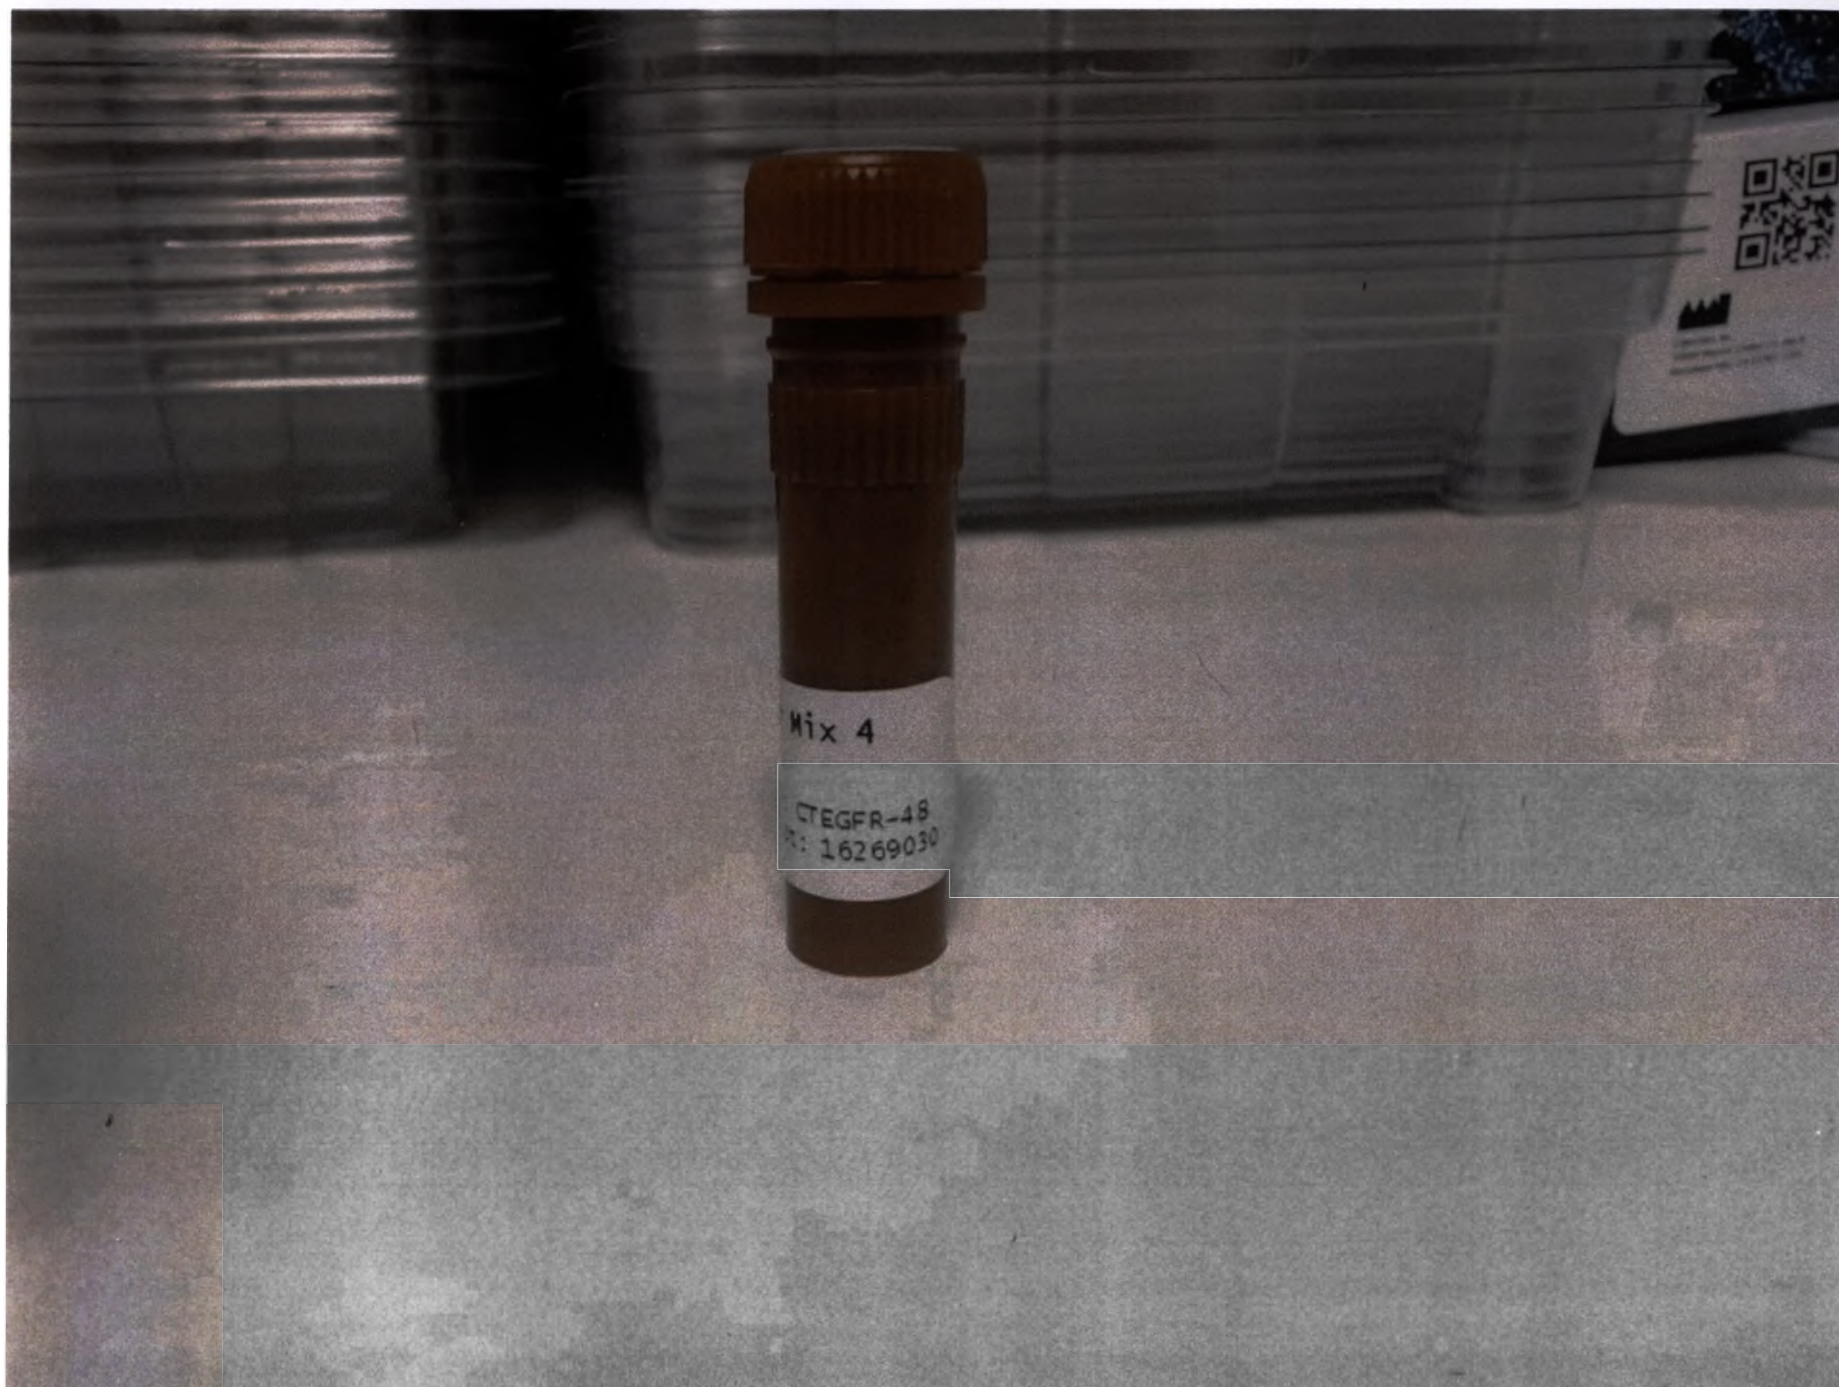


Фото 12. Смесь праймеров / проб, 4я пробирка (вид сверху)

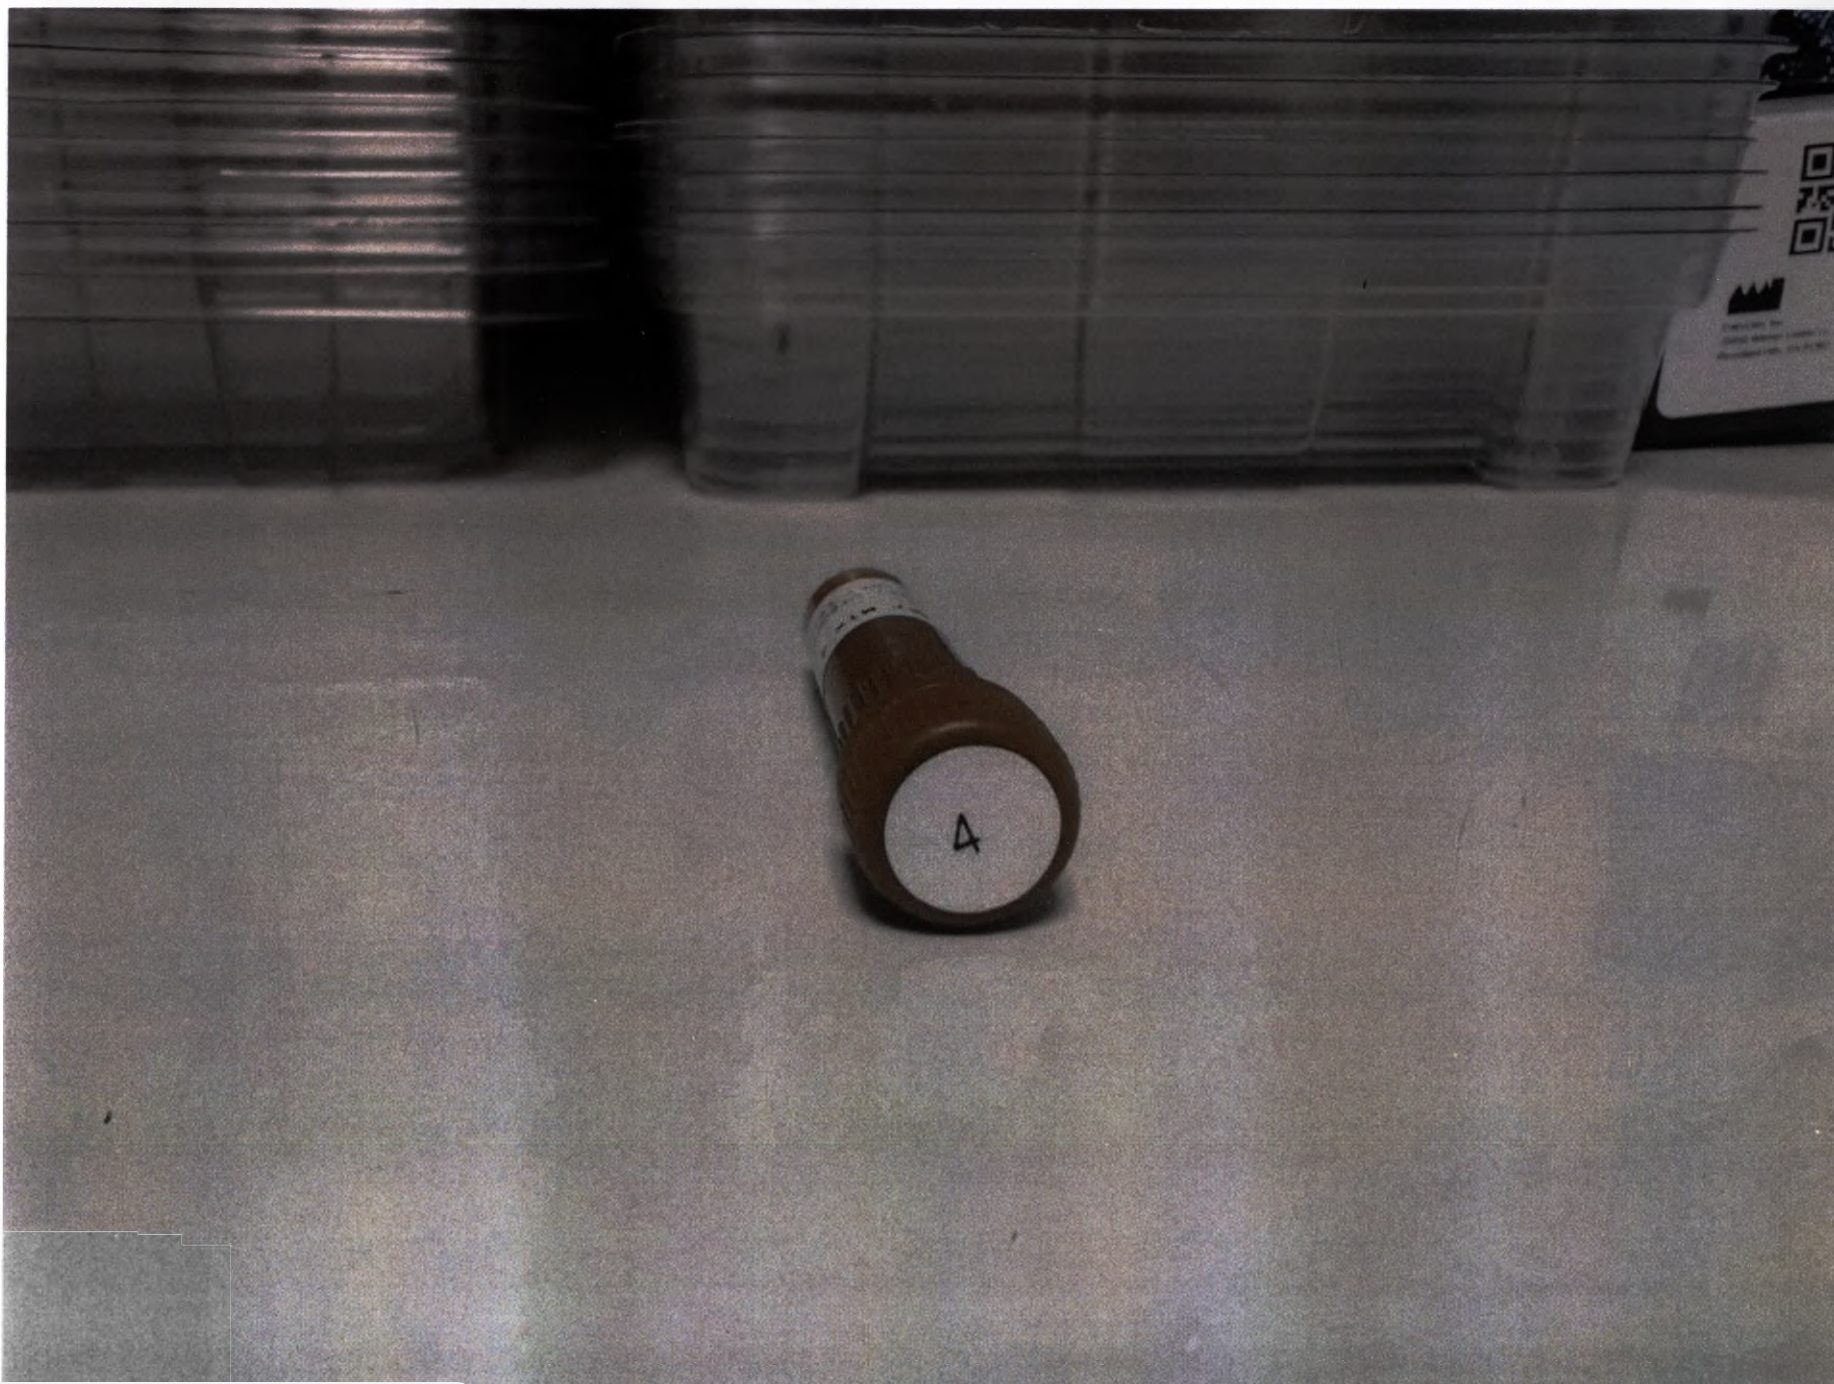


Фото 13. Смесь праймеров / проб. 5я пробирка (вид спереди)

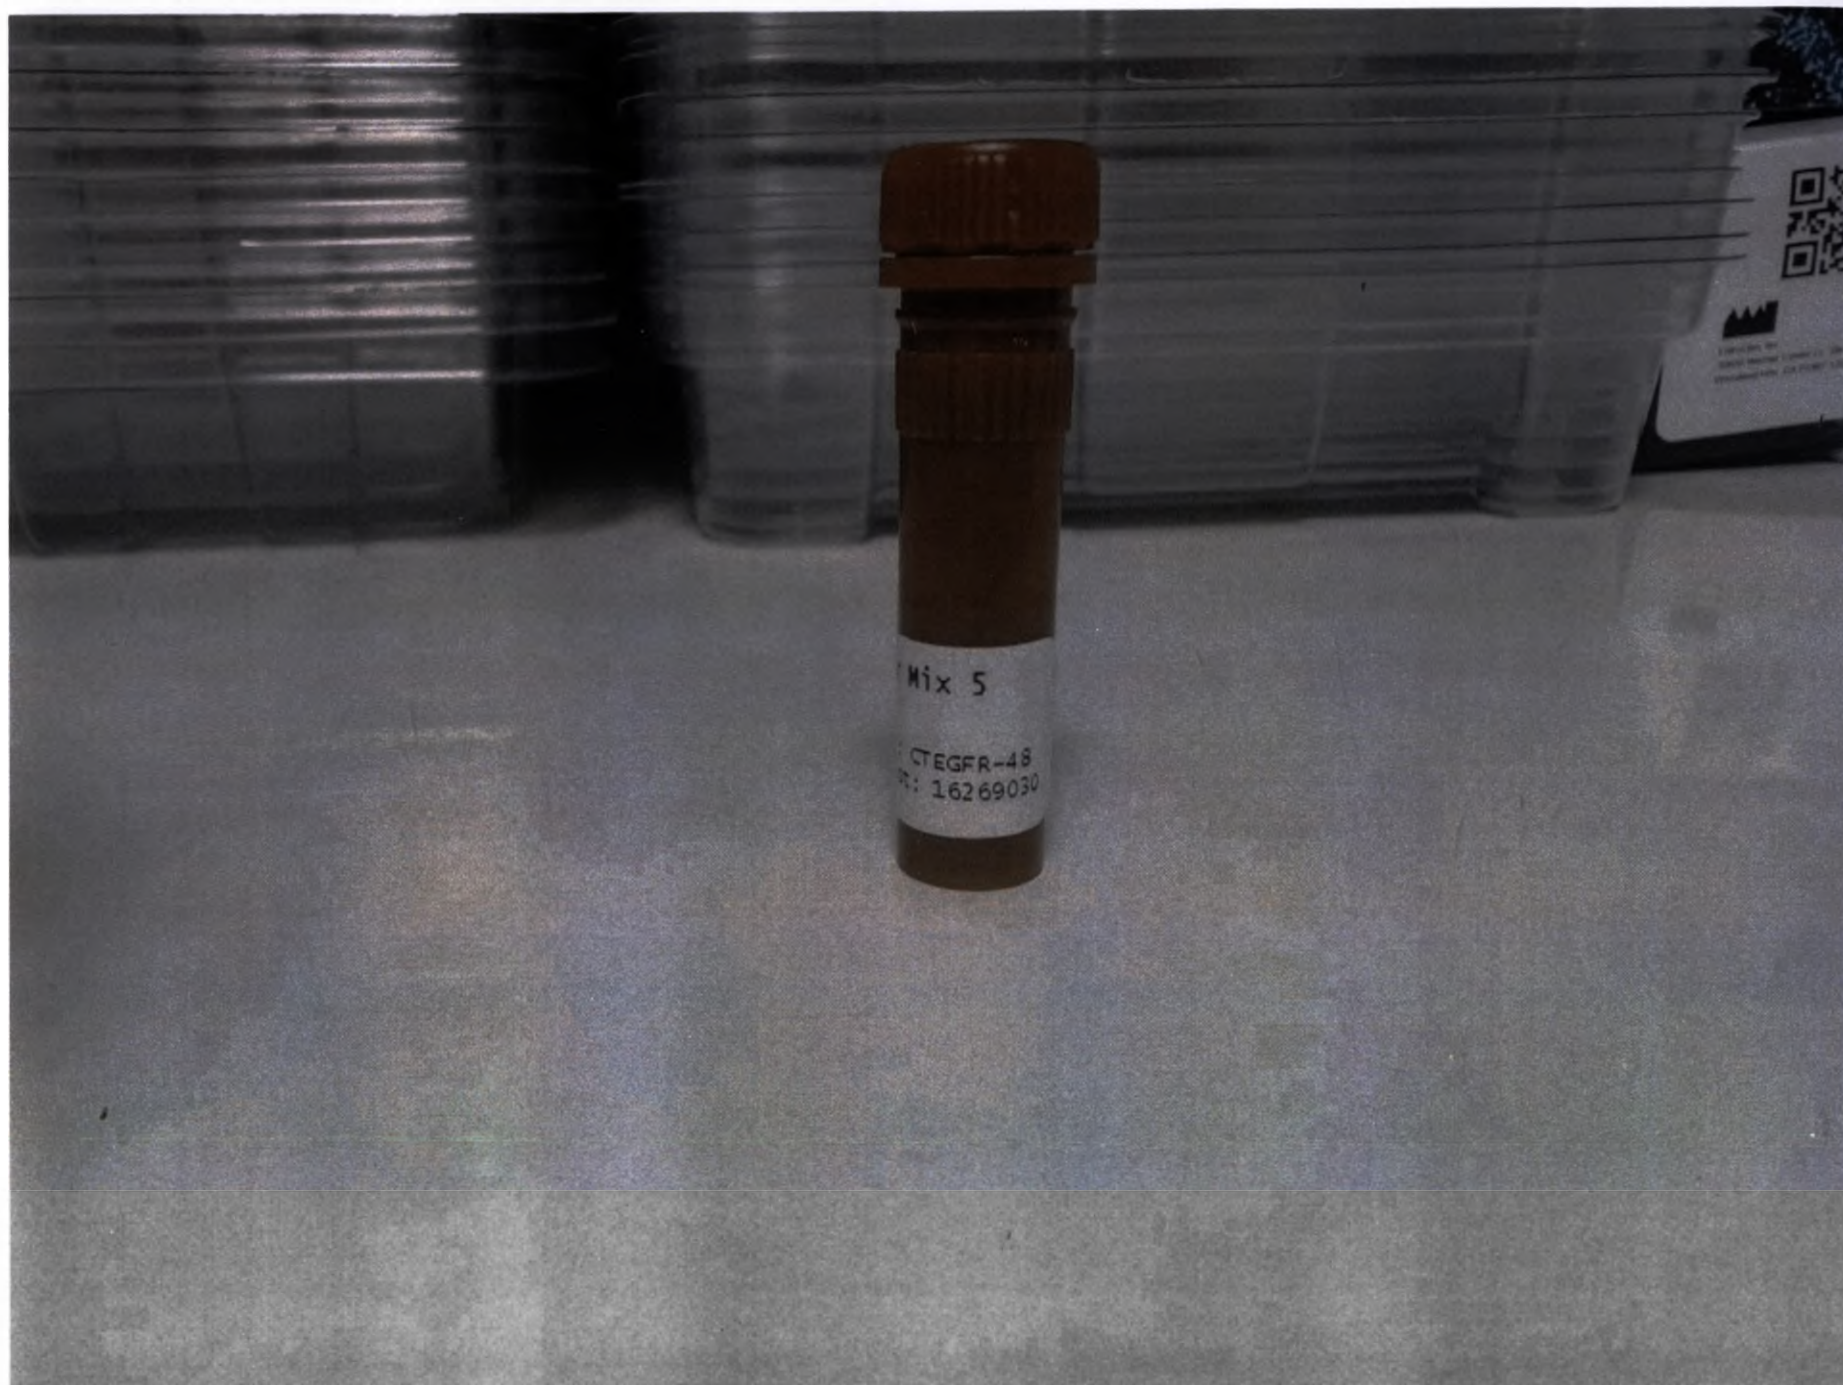


Фото 14. Смесь праймеров / проб, 5я пробирка (вид сверху)

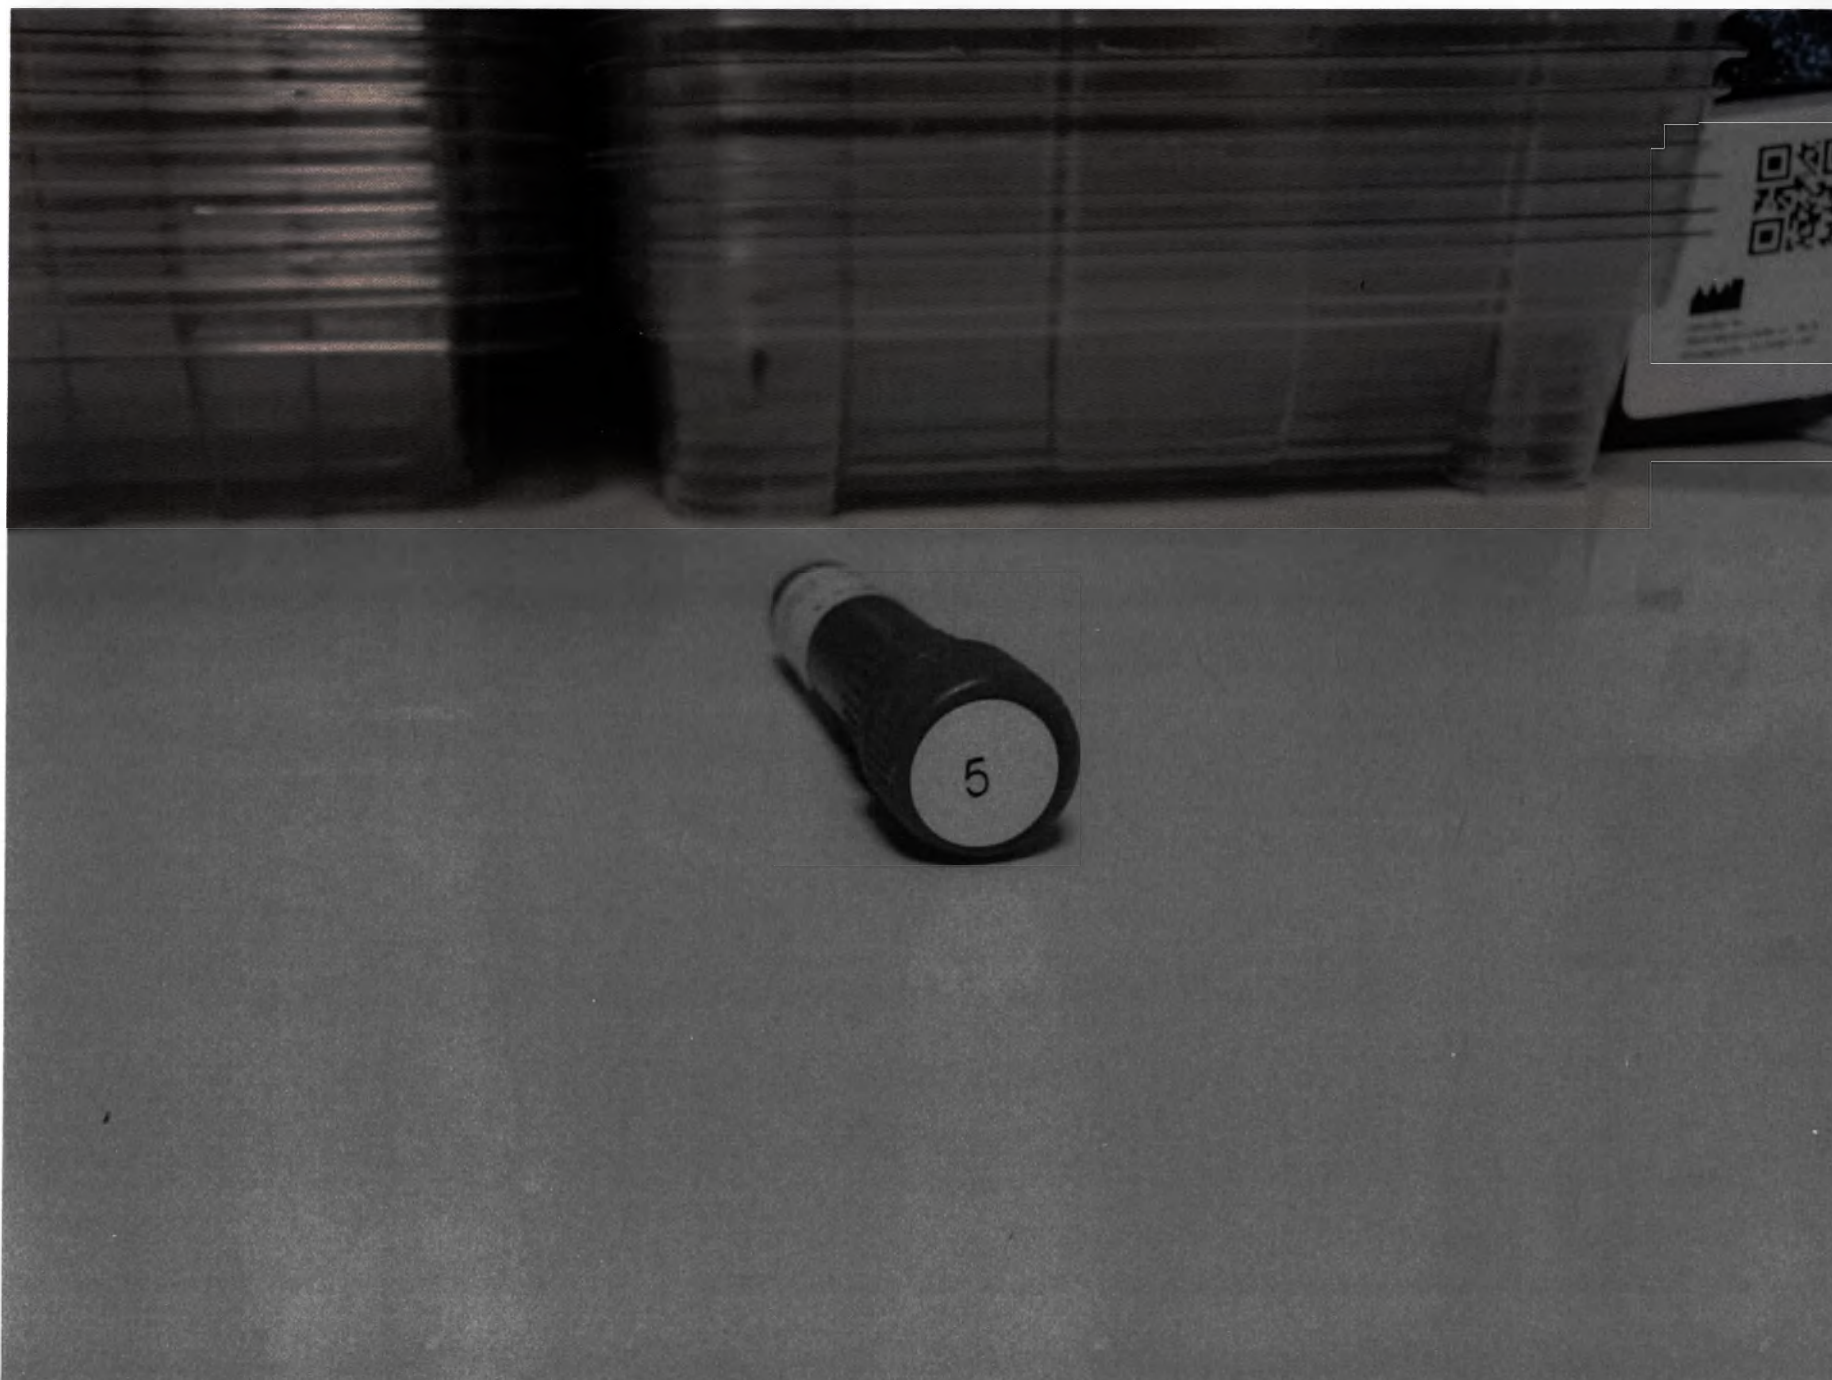


Фото 15. Смесь праймеров / проб. бя пробирка (вид спереди)

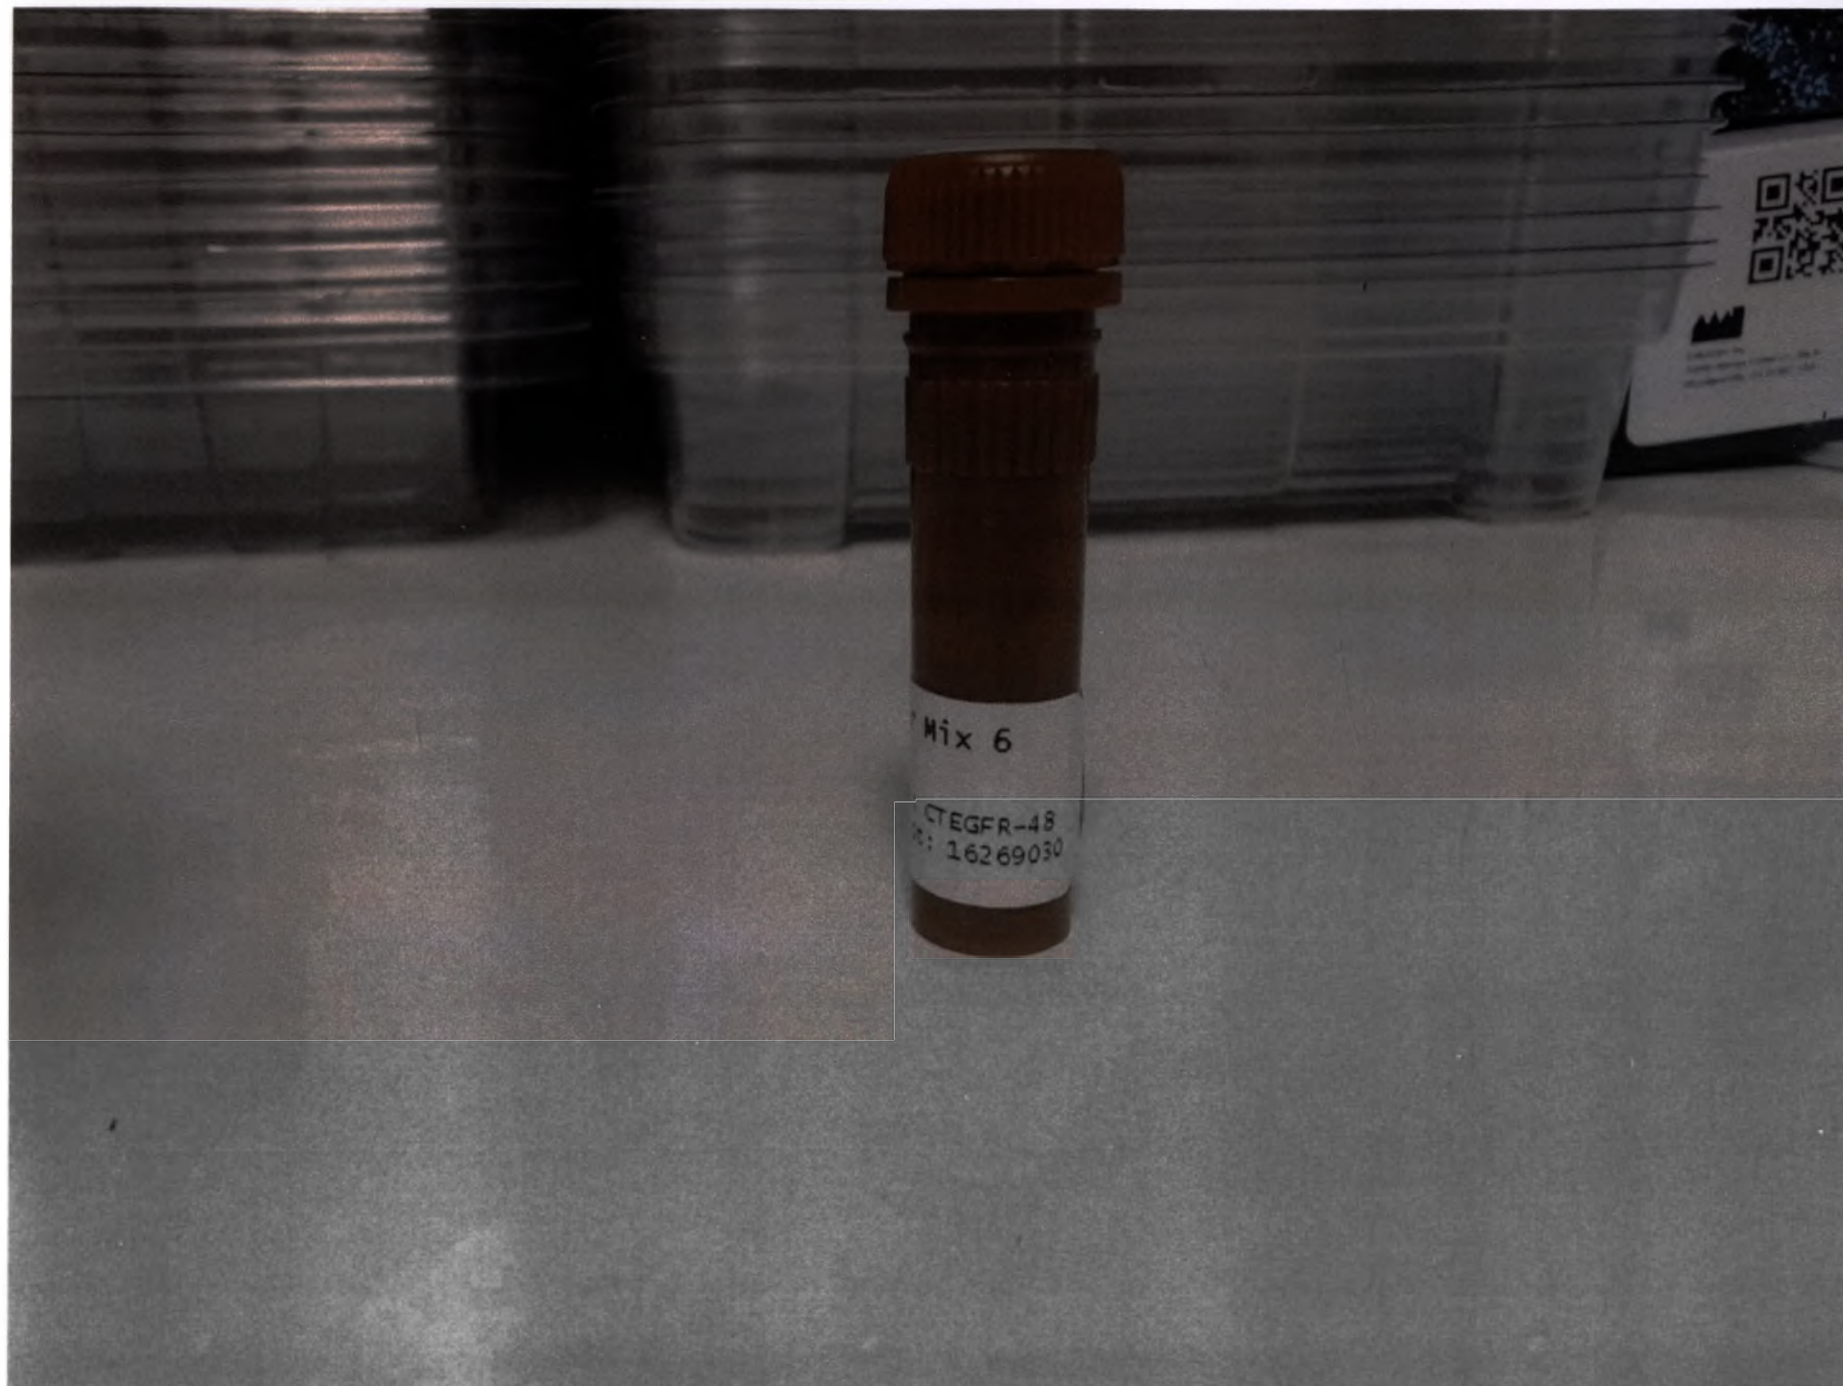


Фото 16. Смесь праймеров / проб, бя пробирка (вид сверху)



Фото 17. Смесь праймеров / проб. 7я пробирка (для сперели)

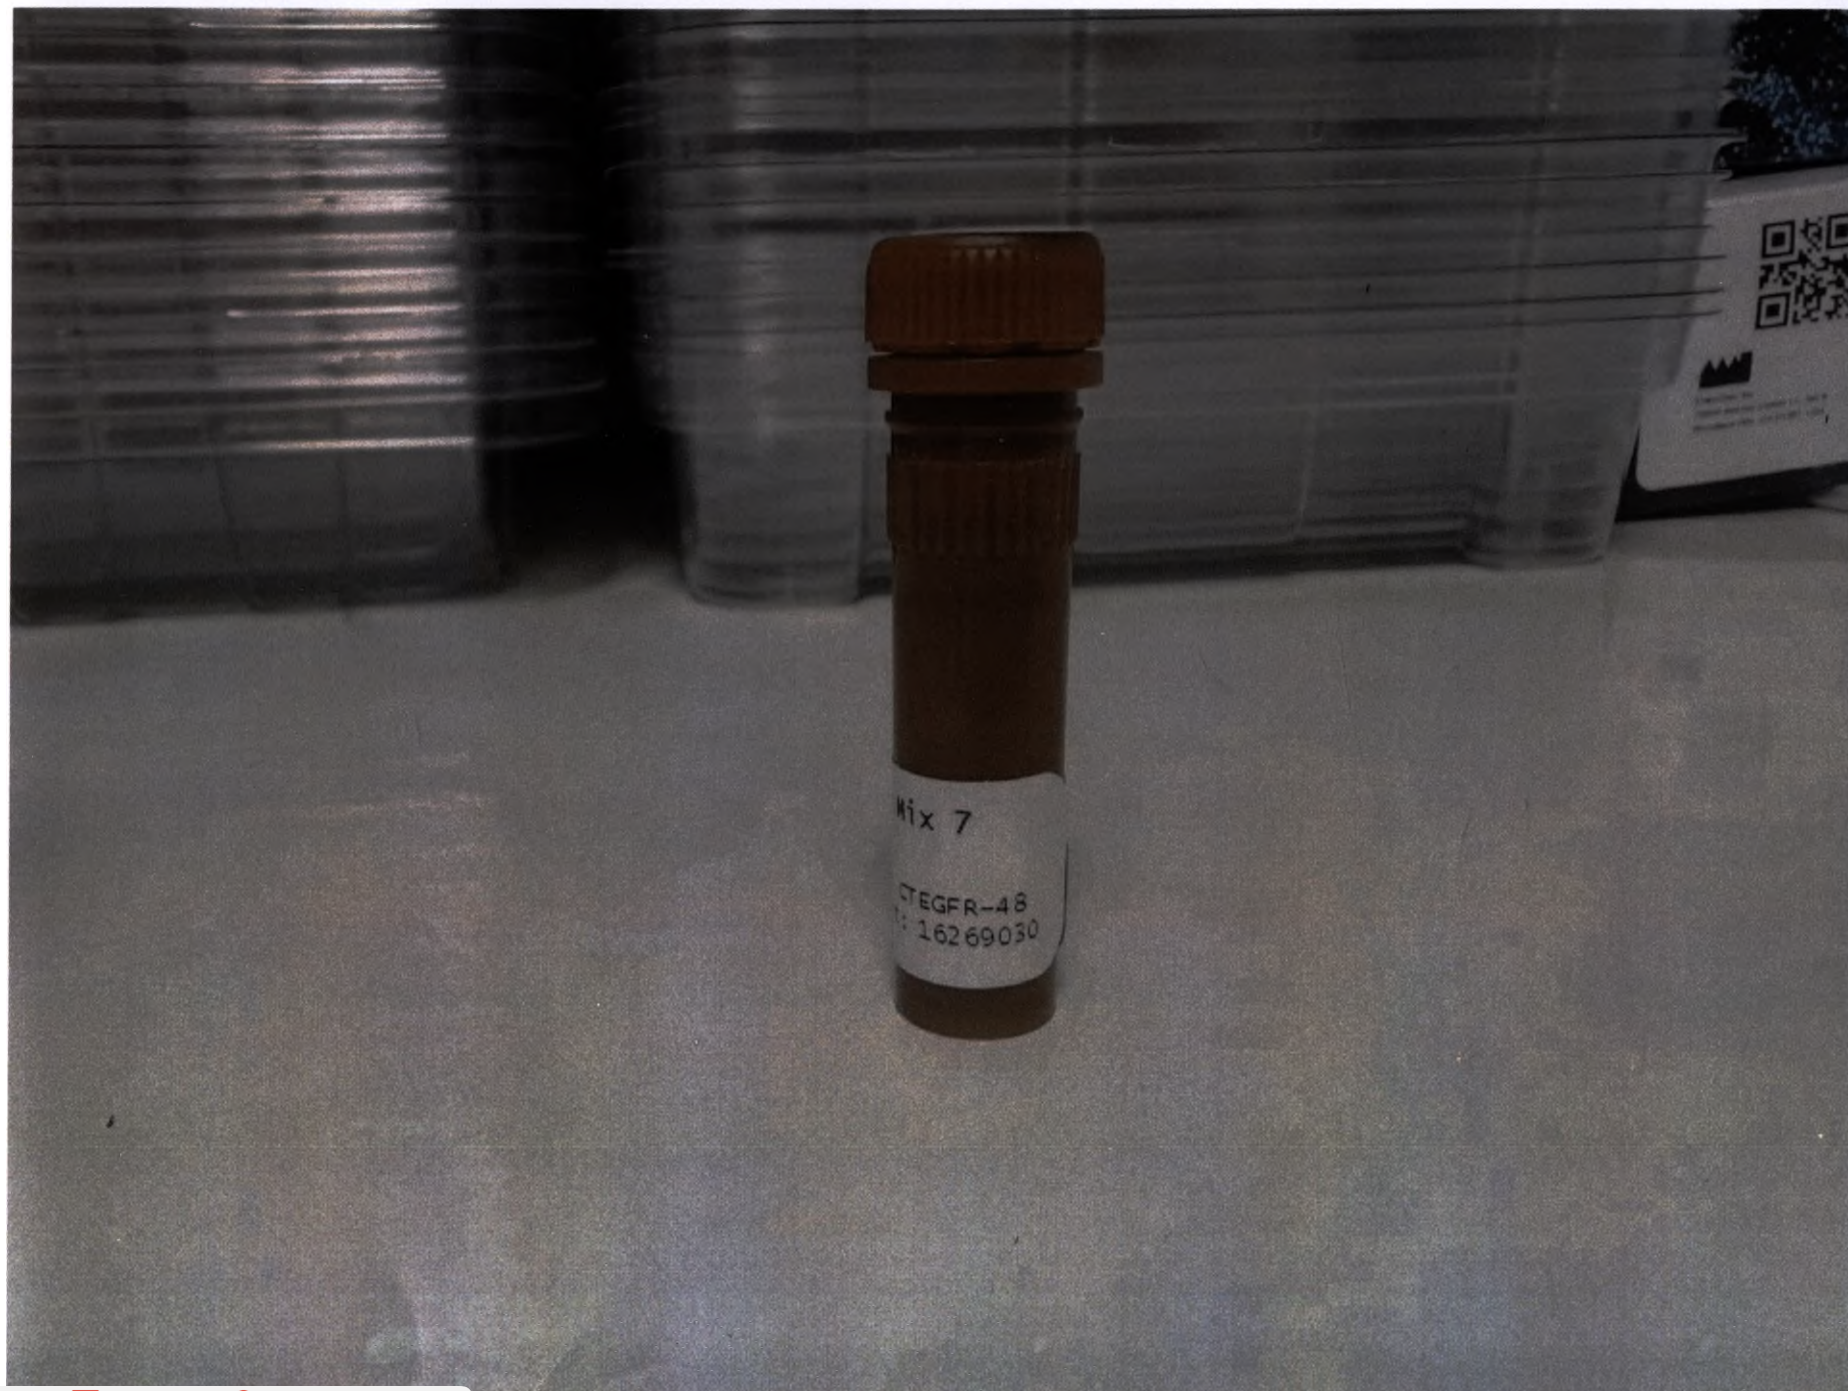


Фото 18. Смесь праймеров / проб. 7я пробирка (вид сверху)

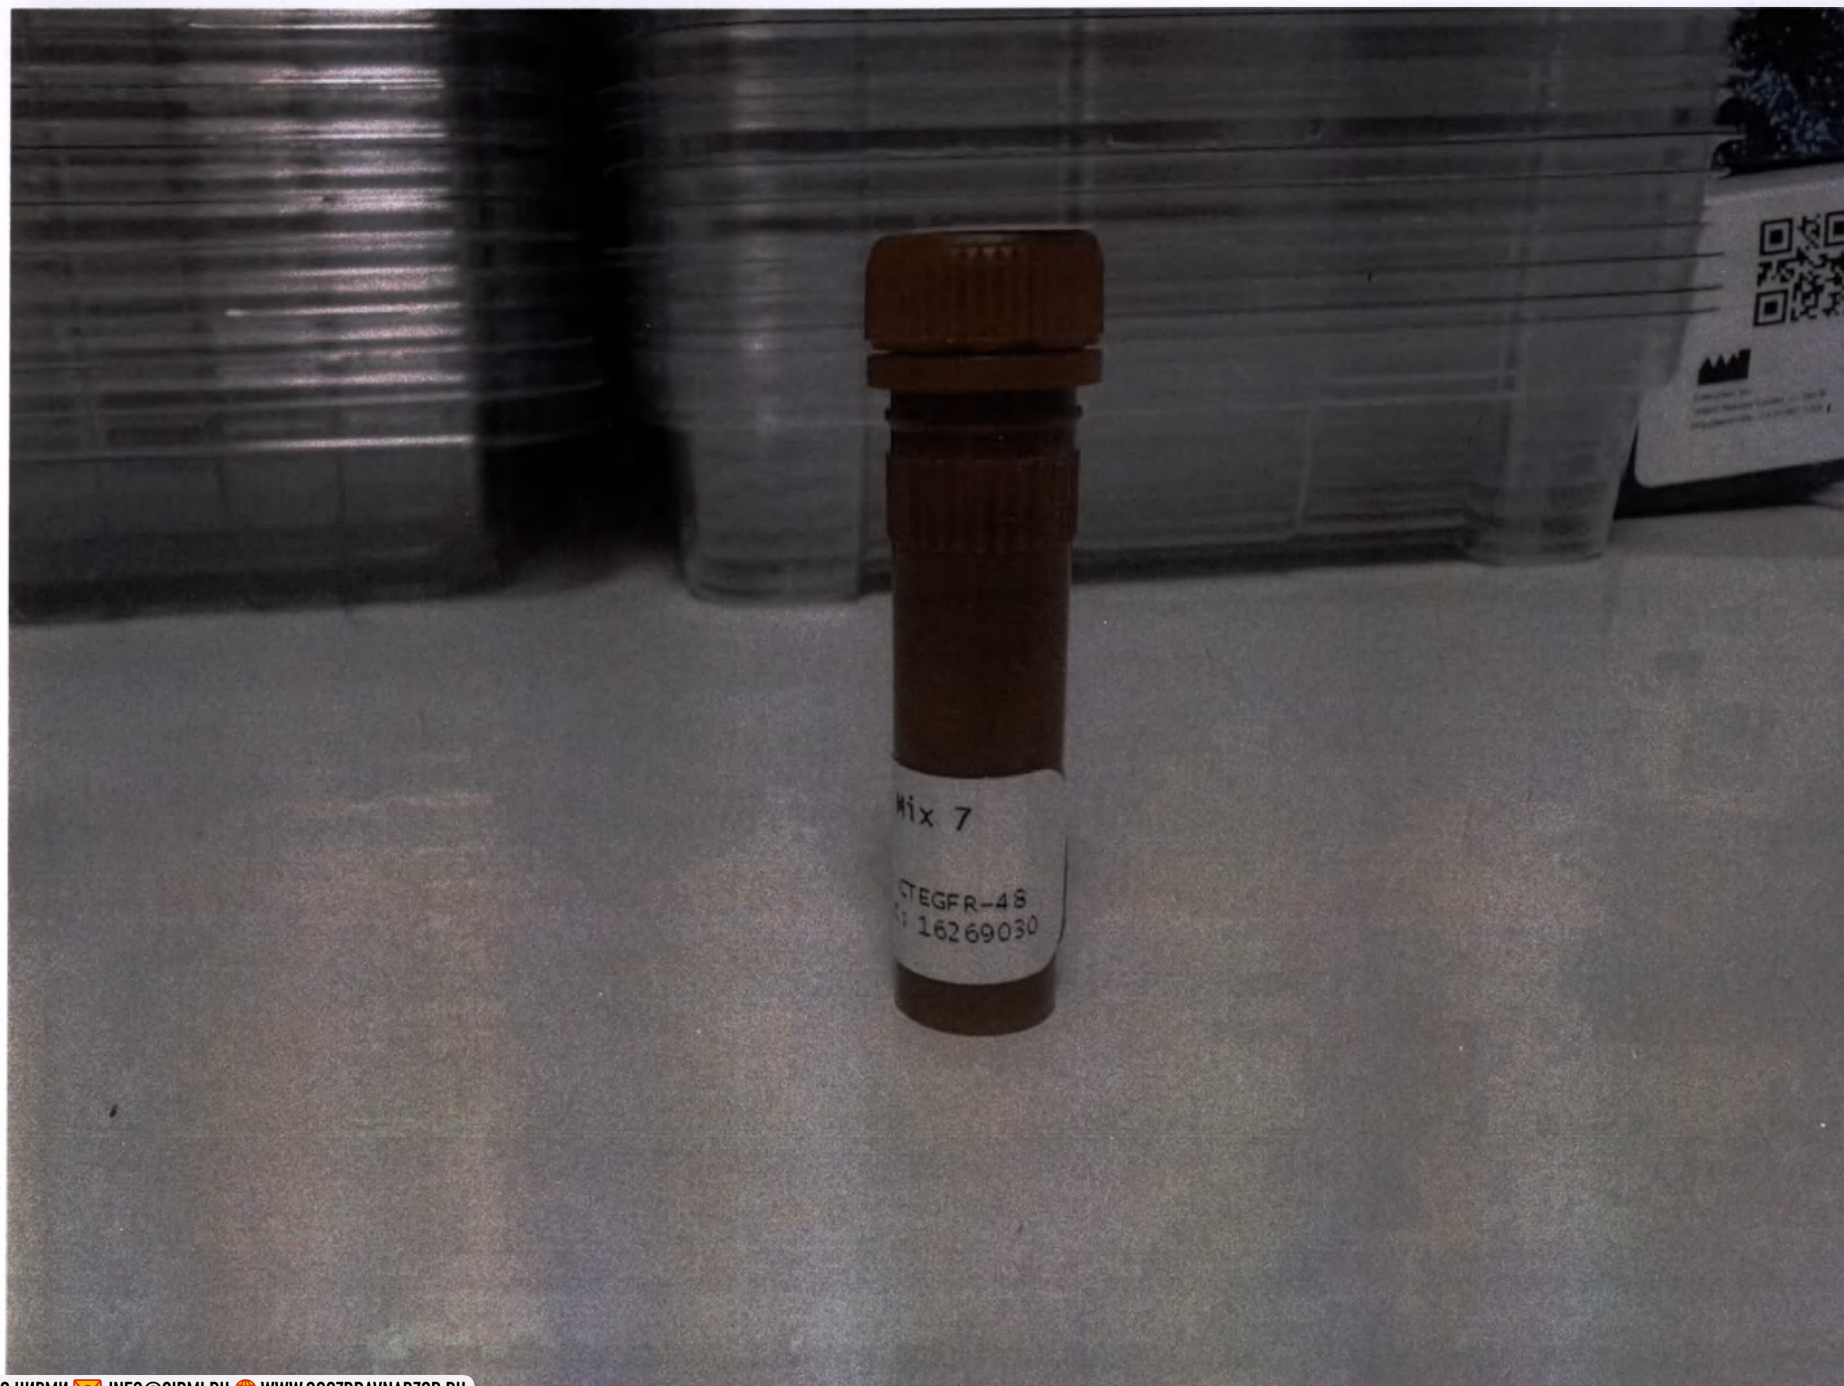


Фото 19. Смесь положительного контроля (ПК) (вид спереди)

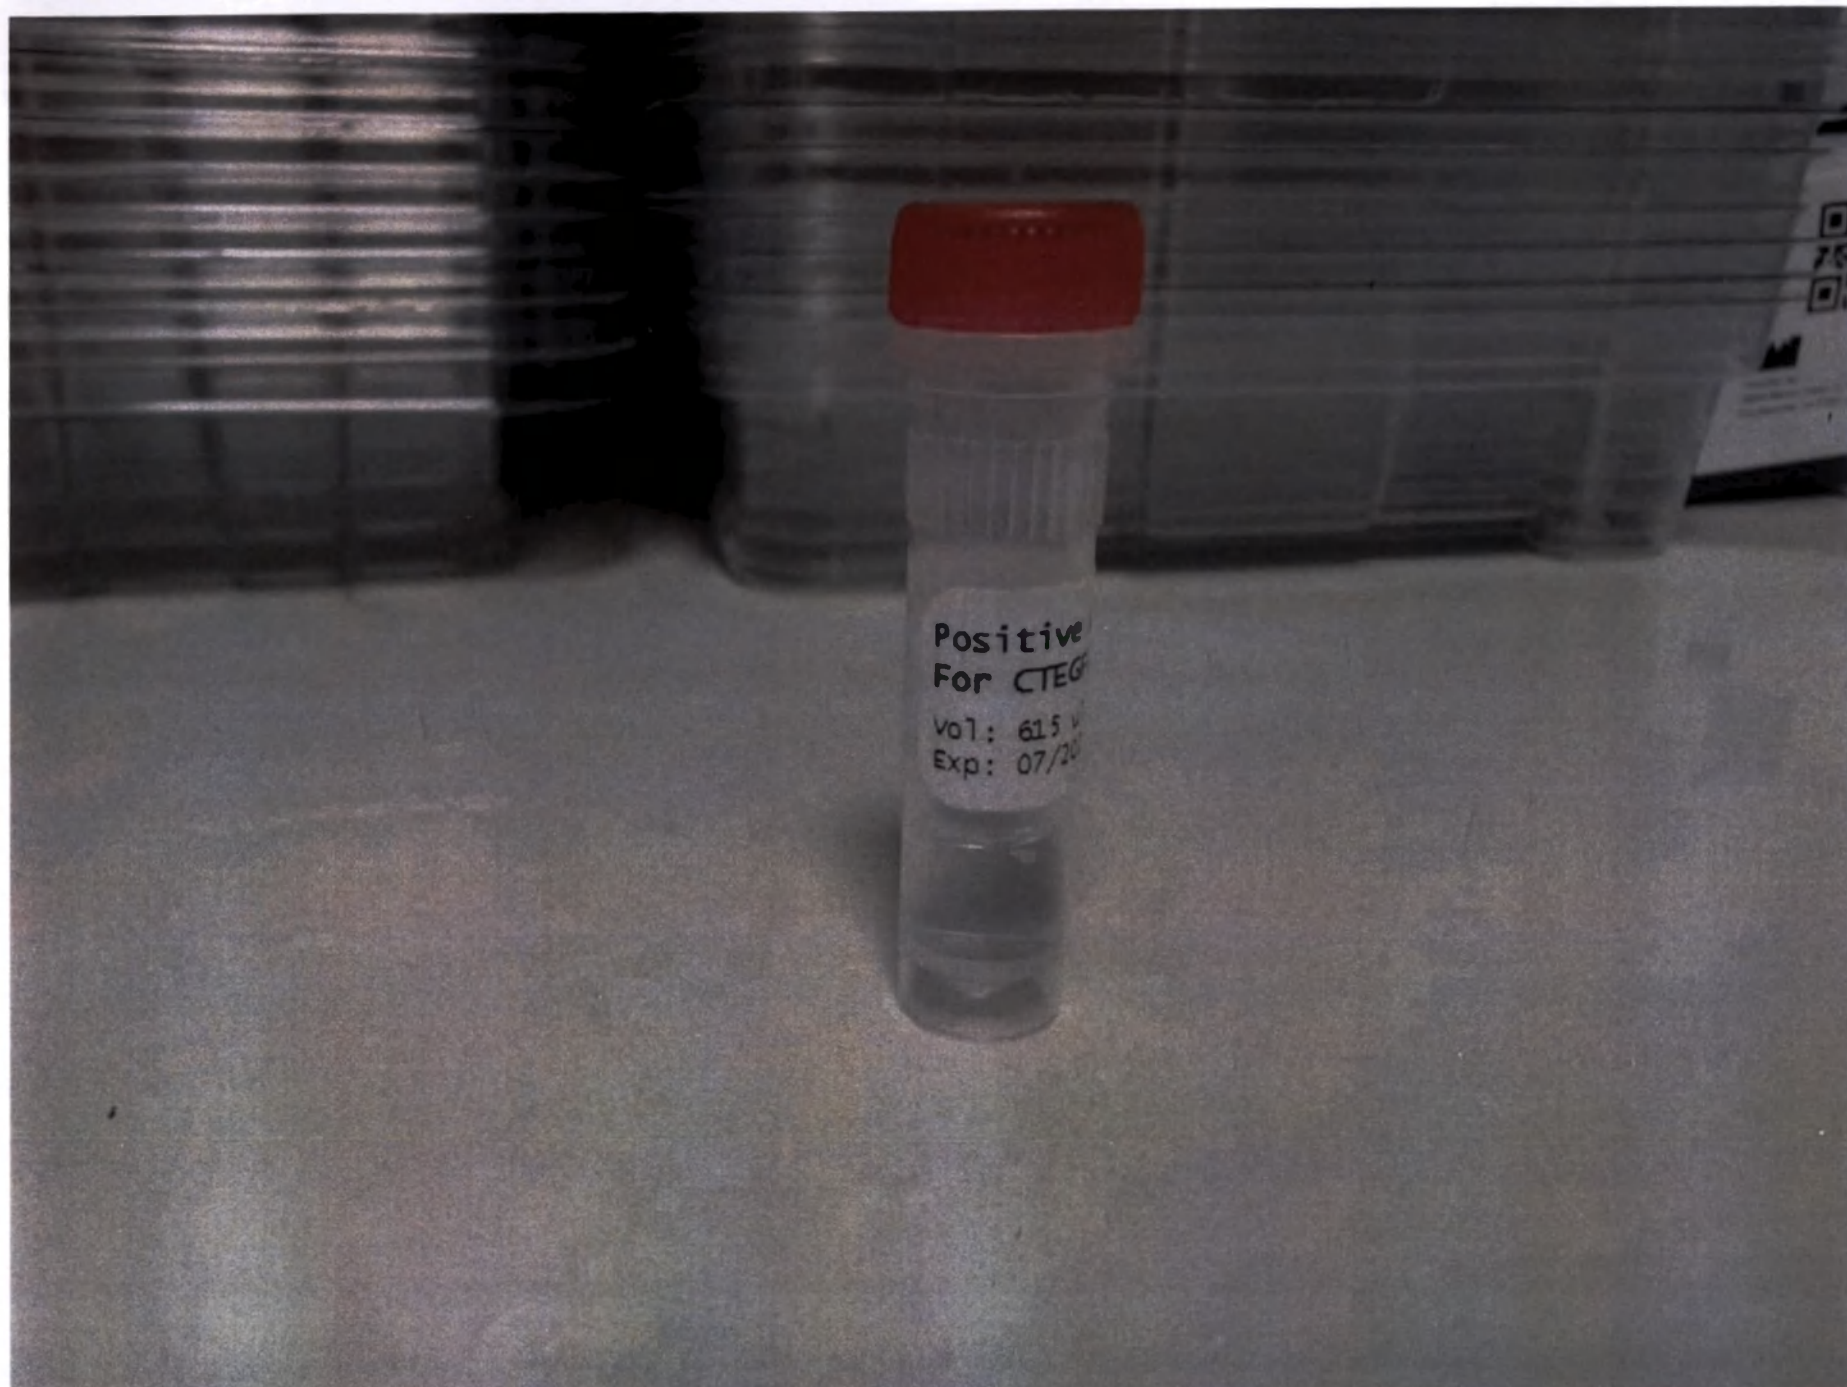


Фото 20. Смесь положительного контроля (ПК) (вид сверху)

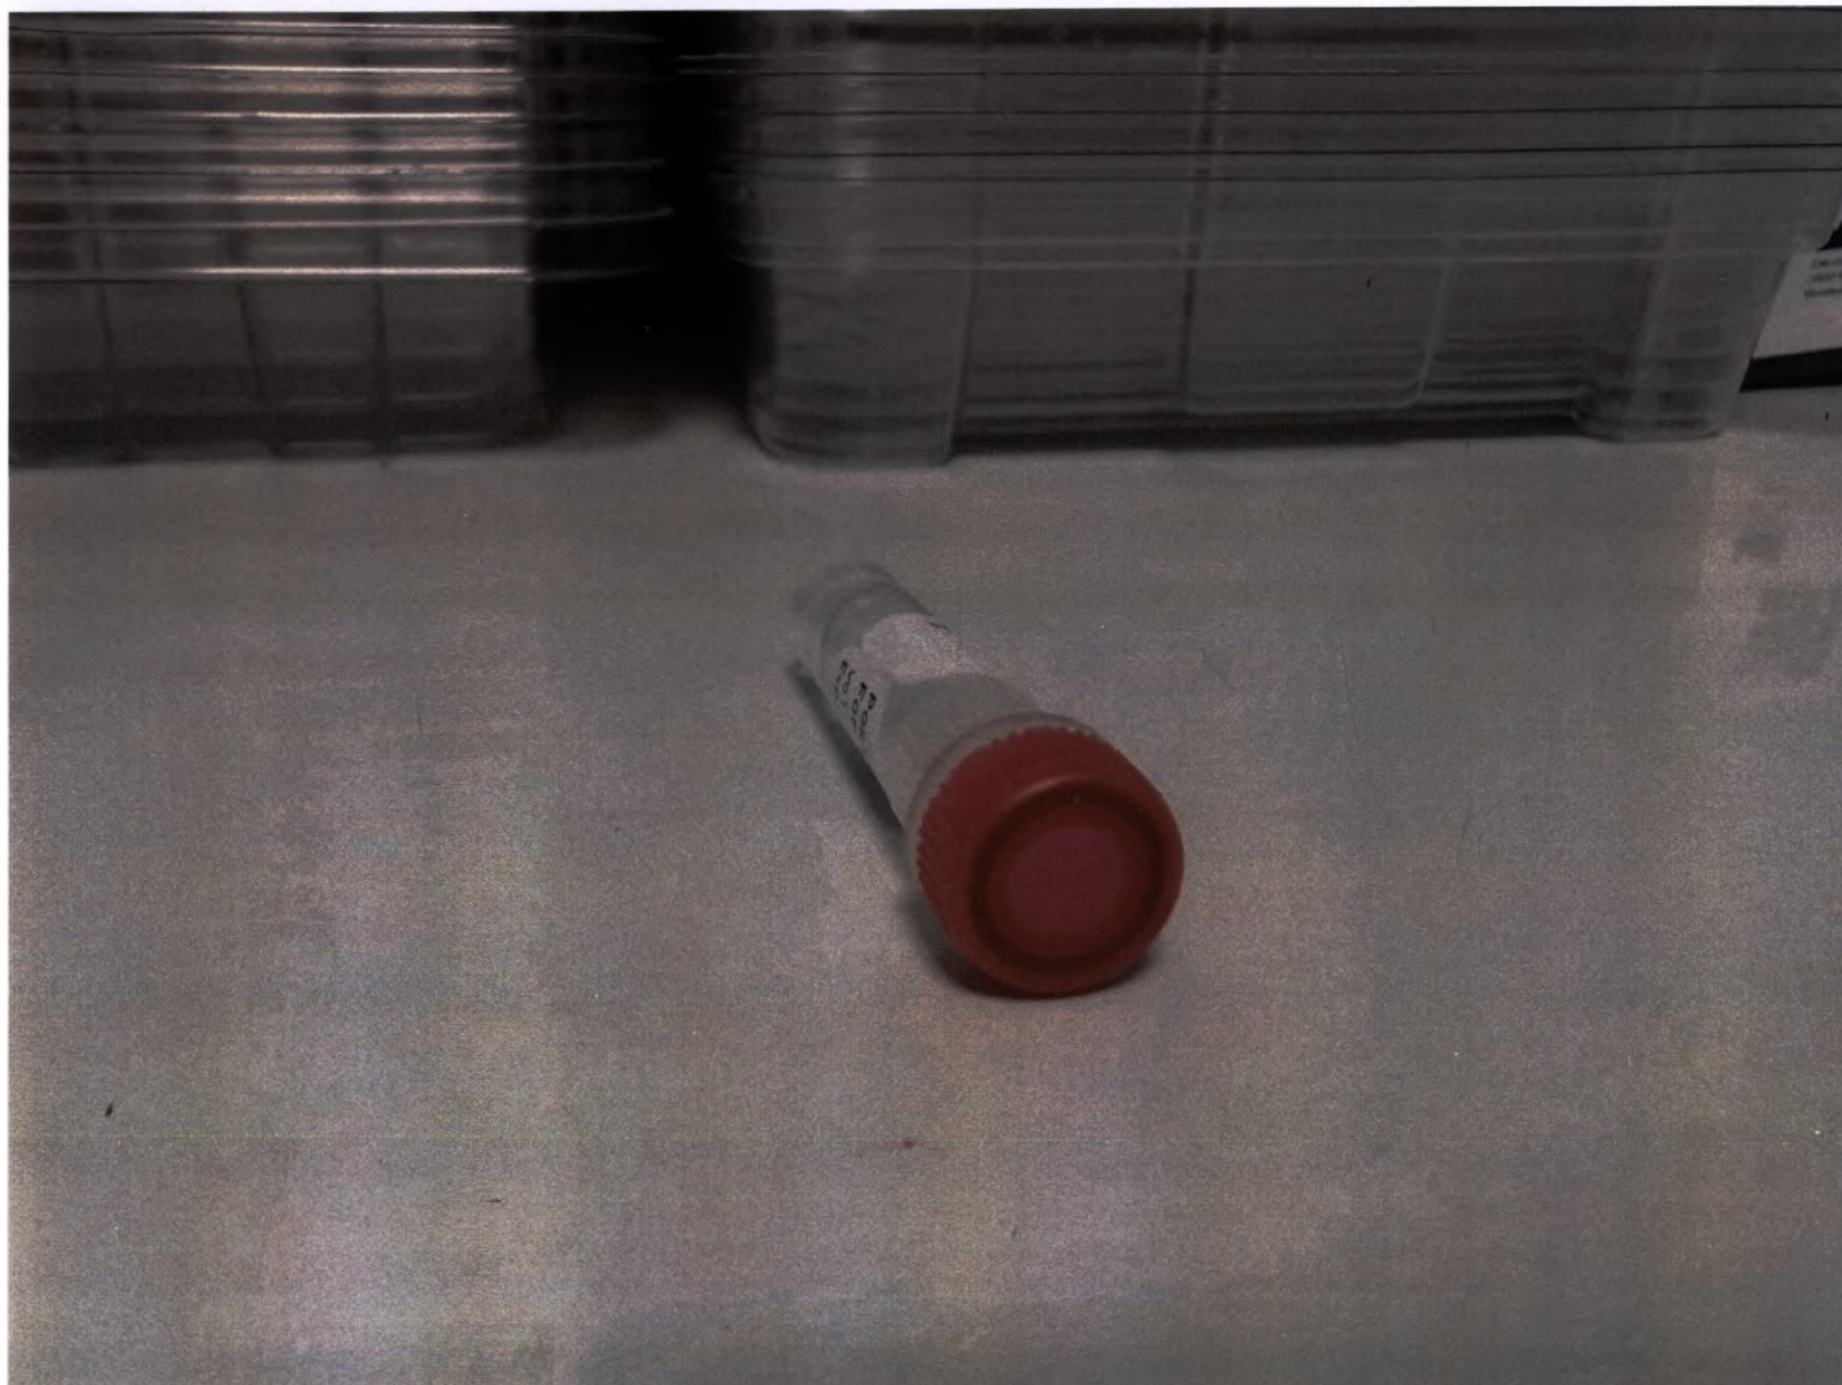


Фото 21. Потребительская упаковка изделия



Фото 22. Потребительская упаковка изделия

ctDNA EGFR Mutation Detection Kit


For Real Time PCR
For detection of EGFR mutations in cell-free DNA

REF CTEGFR-48


LOT 32549896



06/2022



EntroGen, Inc
20950 Warner Center Ln. Ste B
Woodland Hills, CA 91367 USA



Antisel - A. Seldis Bros SA
Spectra Building, 12Nim
Thessaloniki-Halkidiki
PO 57001, Thess, Greece

Рисунок 1. Пример стикера на русском языке

REF	IVD	РУ № РЗН Изделие для профессионального использования	
ctEGFR-48		LOT	
Набор реагентов для <i>in vitro</i> диагностики наличия мутаций гена EGFR методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени в образцах плазмы крови человека, 48 реакций			
Состав: 1. Реакционная смесь 1 для определения мутации цодНК (2X) Для реакции 1, 1 пробирка 2. Реакционная смесь 2 для определения мутации СТ (2X) Для реакций 2-7, 4 пробирки 3. Смесь праймеров / проб, 7 пробирок 4. Смесь положительного контроля (ПК), 1 пробирка 5. Краткая инструкция (при необходимости)			
			
Место производства	EntroGen, Inc. ЭнтроГен, Инк. 20950 Warner Center Ln., suite B, Woodland Hills, California, 91367, USA/ 20950 Ворнер центр Лн., офис Б, Вудлэнд Хиллс, Калифорния, 91367, США		
Уполномоченный представитель производителя	20950 Warner Center Ln., suite B, Woodland Hills, California, 91367, USA/ 20950 Ворнер центр Лн., офис Б, Вудлэнд Хиллс, Калифорния, 91367, США ООО «БиоВитрум» 199106, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большой проспект В.О., дом 68, лит. А. тел./факс: +7 (812) 305-06-06, otk@biovitrum.ru		

Прошито и пронумеровано
25 листа (ов)

Генеральный директор

ООО «БиоВитрум»

О.А. Зиновьев

