

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «ХромсистемсЛаб»

Глаговский П.Б.


2022 г.




**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО
ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO**

**Материал контрольный для контроля качества определения содержания
карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) в сыворотке крови
человека методом жидкостной хроматографии «Сывороточный
контроль Уровень I. CDT в сыворотке» в вариантах исполнения**


2022 г.

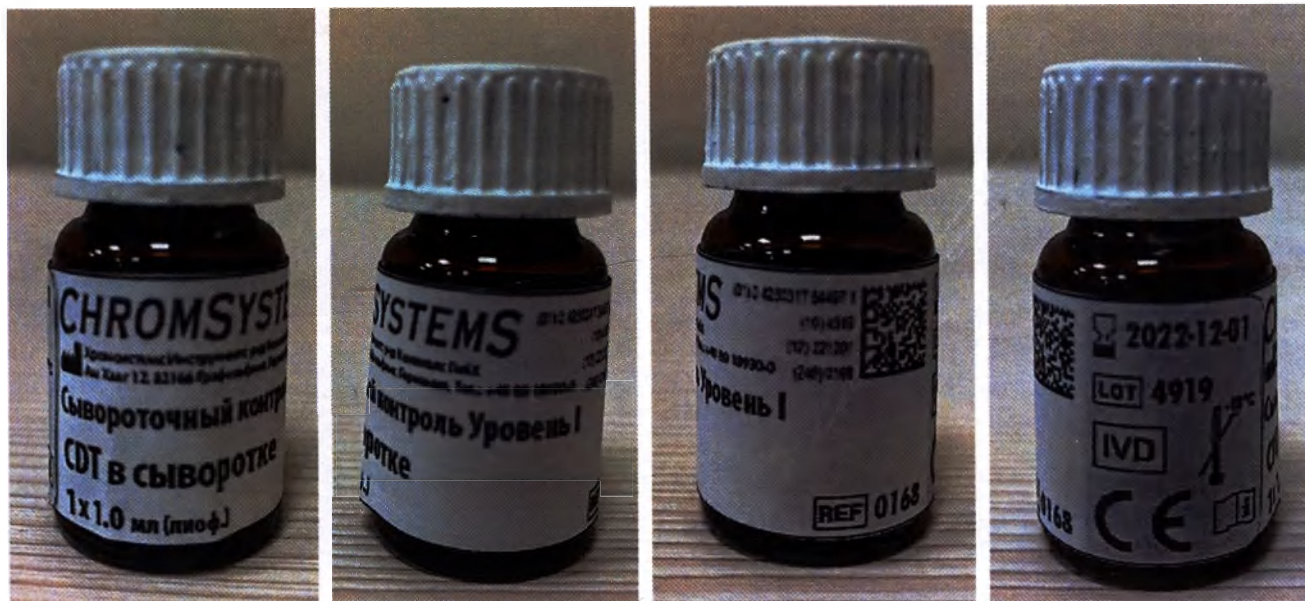


Фотографические изображения 1-4. Внешний вид индивидуальной упаковки вариантов исполнения 1 и 2

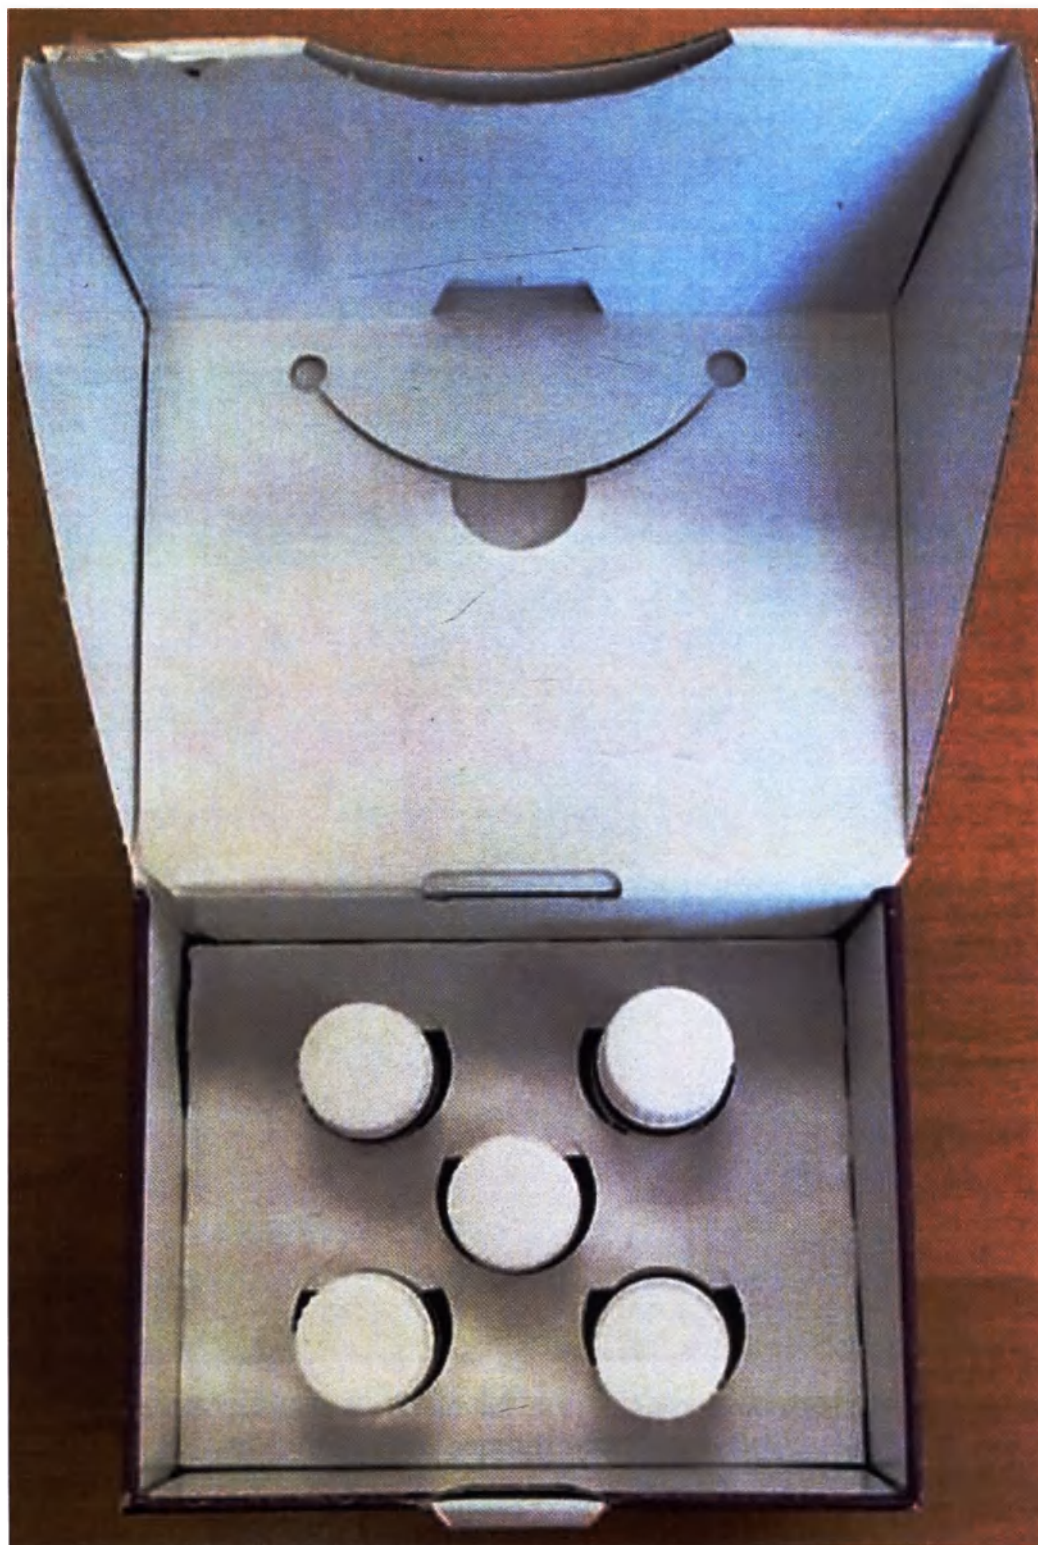


Фотографическое изображение 5 - Внешний вид медицинского изделия в потребительской упаковке, вариант исполнения 1

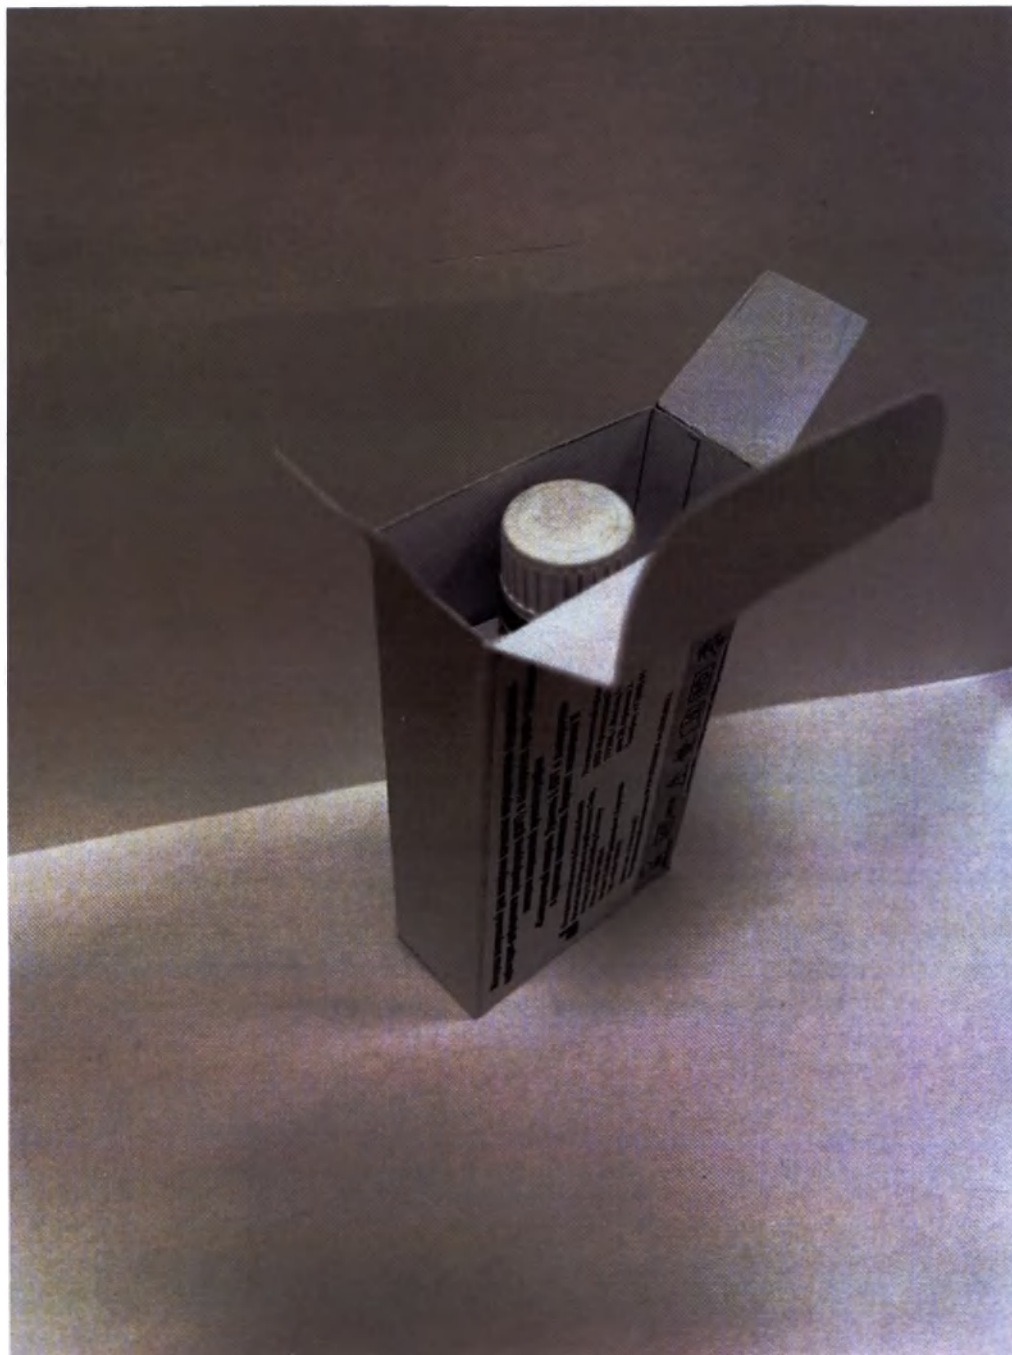

Фотографическое изображение 6 - Внешний вид медицинского изделия в потребительской упаковке, вариант исполнения 2

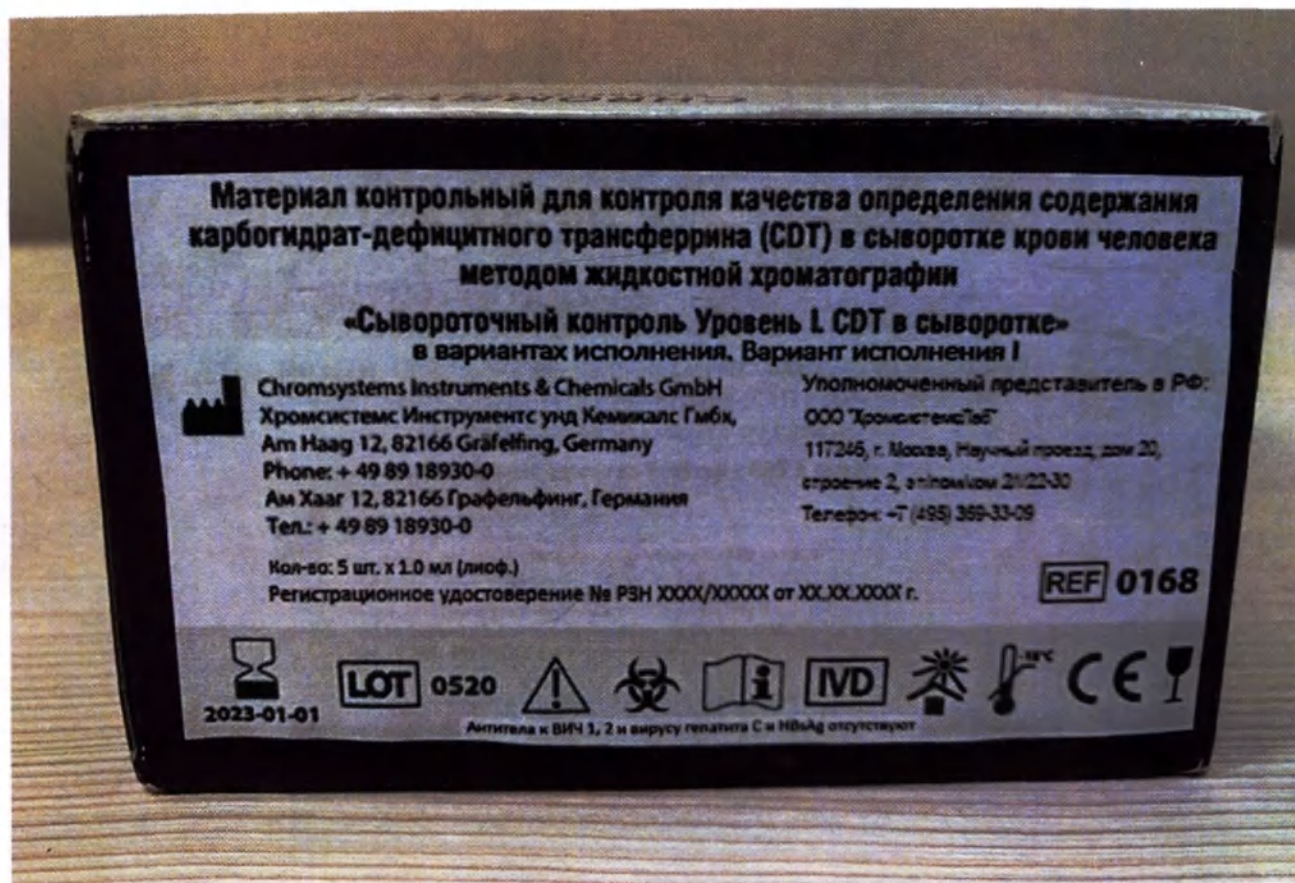

Фотографическое изображение 7 – Маркировка медицинского изделия в потребительской упаковке, вариант исполнения 1

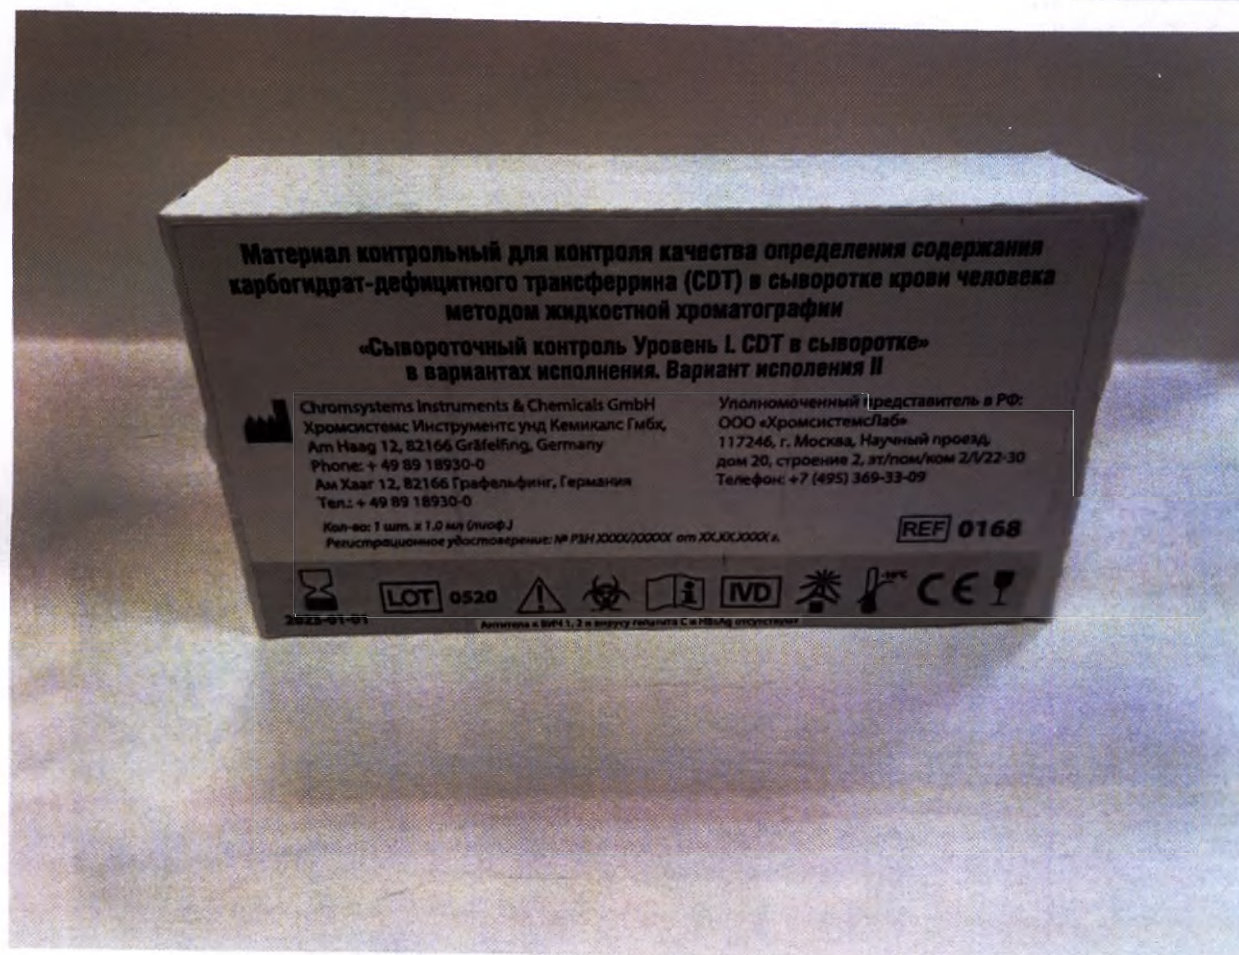

Фотографическое изображение 8 – Маркировка медицинского изделия в потребительской упаковке, вариант исполнения 2

Пронумеровано, прошито и

скреплено печатью 6 листов.



Глаговский П.Б.

генеральный директор ООО «ХромсистемсЛаб»

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «ХромсистемсЛаб»

Глазовский П.Б.

«систем» 2022 г.



МАКЕТ МАРКИРОВКИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Материал контрольный для контроля качества определения содержания
карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) в сыворотке крови
человека методом жидкостной хроматографии «Сывороточный контроль
Уровень I. CDT в сыворотке» в вариантах исполнения

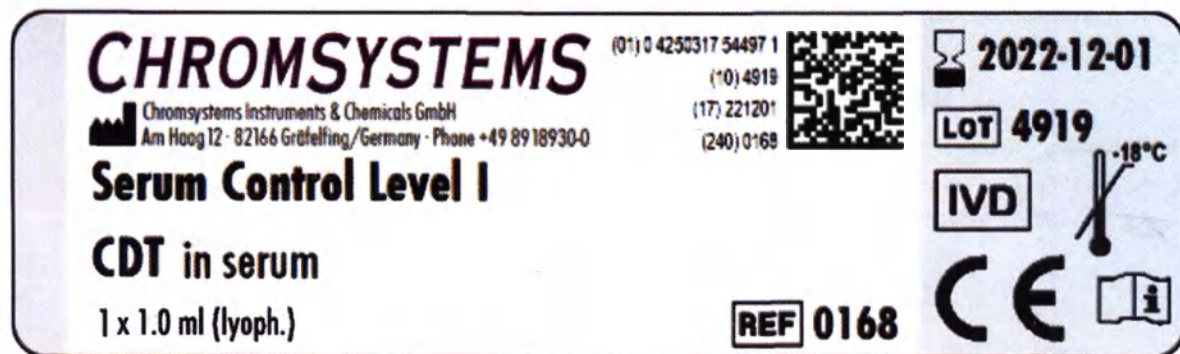


Рисунок 1 – Макет маркировки индивидуальной упаковки (флакона) вариантов исполнения 1 и 2



Рисунок 2 – Перевод макета маркировки индивидуальной упаковки (флакона) вариантов исполнения 1 и 2

**Материал контрольный для контроля качества определения содержания
карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) в сыворотке крови человека
методом жидкостной хроматографии**

**«Сывороточный контроль Уровень I. CDT в сыворотке»
в вариантах исполнения. Вариант исполнения I**

 Chromsystems Instruments & Chemicals GmbH
Хромсистемс Инструментс унд Кемикалс Гмбх,
Am Haag 12, 82166 Gräfelfing, Germany
Phone: + 49 89 18930-0
Am Haag 12, 82166 Графельфинг, Германия
Тел.: + 49 89 18930-0

Уполномоченный представитель в РФ:
ООО "ХромсистемсЛаб"
117246, г. Москва, Научный проезд, дом 20,
строение 2, эт/пом/ком 2/1/22-30
Телефон: +7 (495) 369-33-09

Кол-во: 5 шт. x 1.0 мл (лиоф.)

Регистрационное удостоверение № РЗН XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX г.

REF 0168




Рисунок 3 – Макет маркировки потребительской упаковки для варианта исполнения 1

**Материал контрольный для контроля качества определения содержания
карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) в сыворотке крови человека
методом жидкостной хроматографии**

**«Сывороточный контроль Уровень I. CDT в сыворотке»
в вариантах исполнения. Вариант исполнения II**

 Chromsystems Instruments & Chemicals GmbH
Хромсистемс Инструментс унд Кемикалс Гмбх,
Am Haag 12, 82166 Gräfelfing, Germany
Phone: + 49 89 18930-0
Am Haag 12, 82166 Графельфинг, Германия
Тел.: + 49 89 18930-0

Уполномоченный представитель в РФ:
ООО "ХромсистемсЛаб"
117246, г. Москва, Научный проезд, дом 20,
строение 2, эт/пом/ком 2/1/22-30
Телефон: +7 (495) 369-33-09

Кол-во: 1 шт. x 1.0 мл (лиоф.)

Регистрационное удостоверение: № РЗН XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX г.

REF 0168




Рисунок 4 – Макет маркировки потребительской упаковки для варианта исполнения 2

Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью 3 листов



Глаговский П.Б.
Генеральный директор ООО «ХромсистемсЛаб»