


Фотографические изображения общего вида на медицинское изделие

Набор реагентов для количественного определения альбумина в сыворотке или плазме крови человека колориметрическим методом с использованием бромкрезолового пурпурного на биохимических анализаторах Alinity с «Alinity с Альбумин бромкрезоловый пурпурный Реагенты (Alinity с Albumin BCP Reagent Kit)»


(размером не менее 18 x 24 сантиметра)

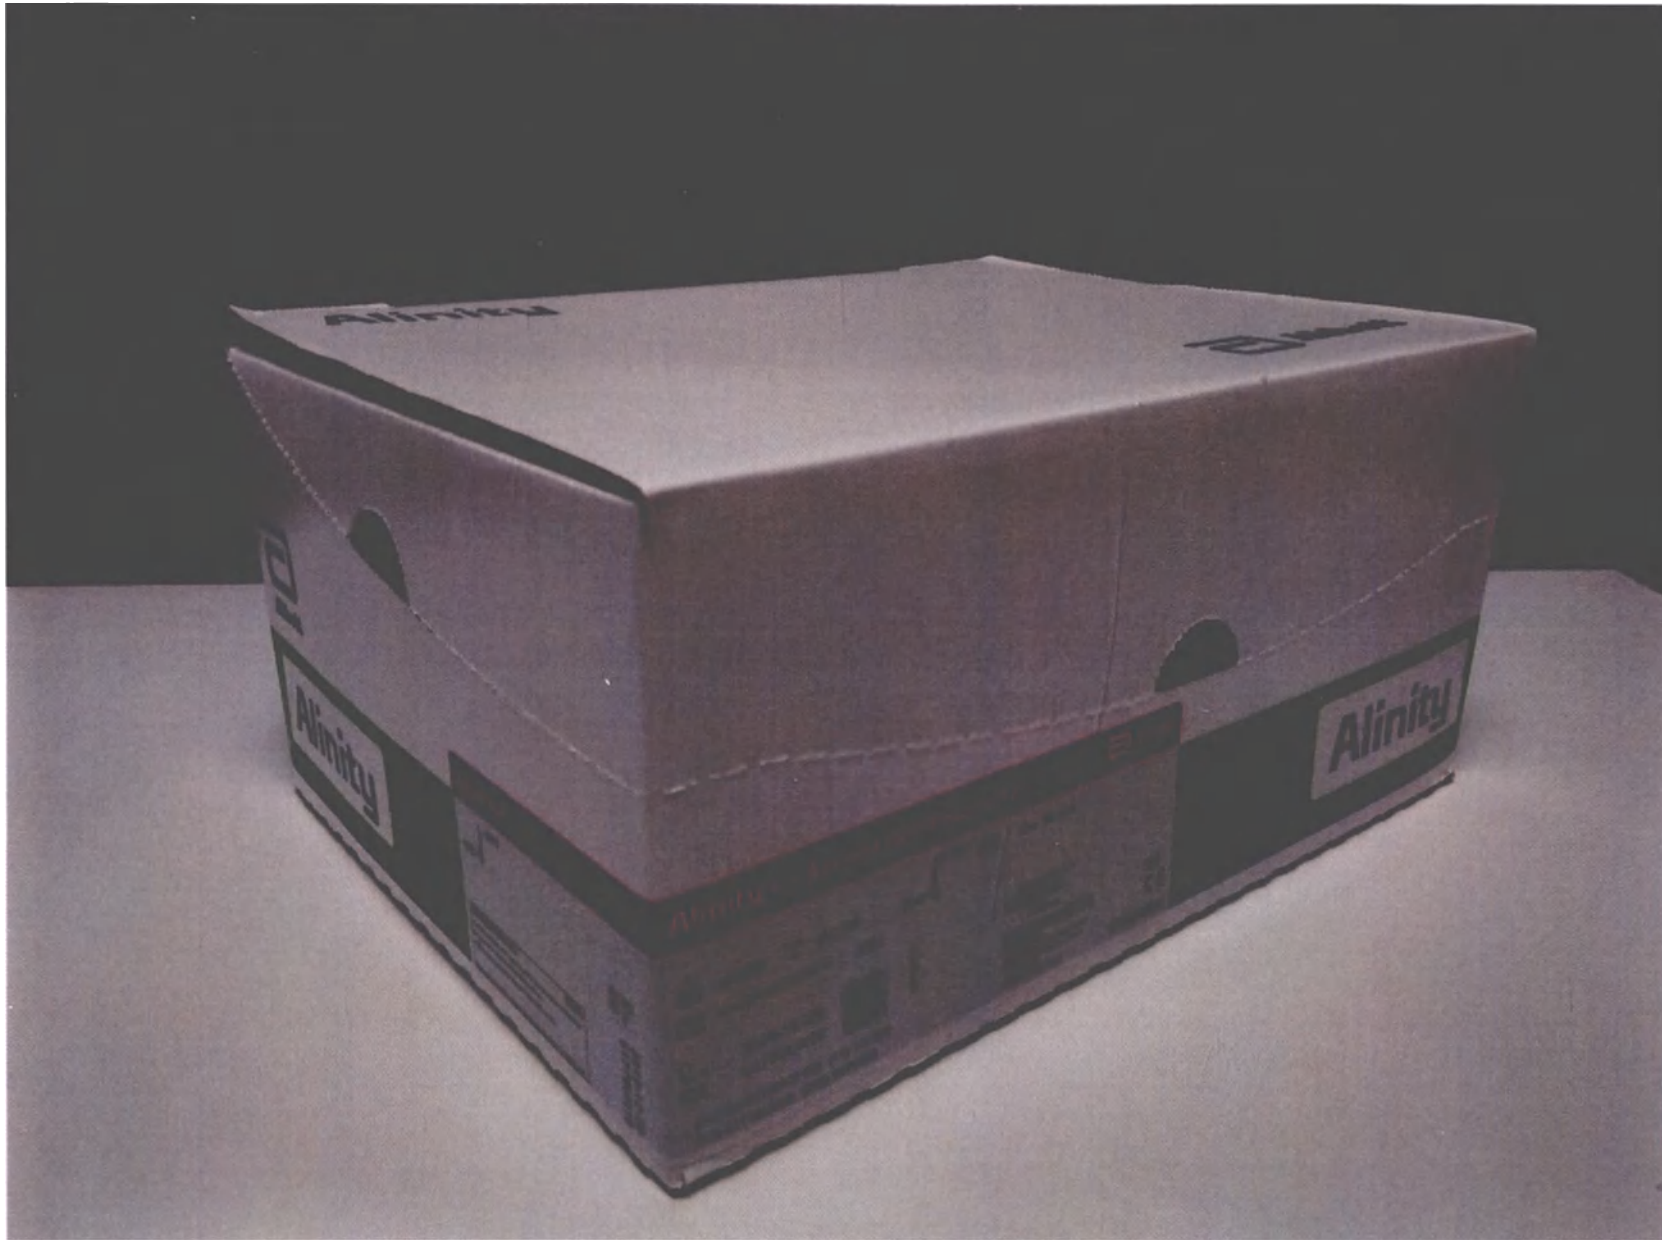

Фотографическое изображение открытой упаковки «Alinity с Альбумин бромкрезоловый пурпурный Реагенты (Alinity с Albumin BCP Reagent Kit)»



Фотографическое изображение упаковки и картриджей «Alinity с Альбумин бромкрезоловый пурпурный Реагенты (Alinity с Albumin BCP Reagent Kit)»

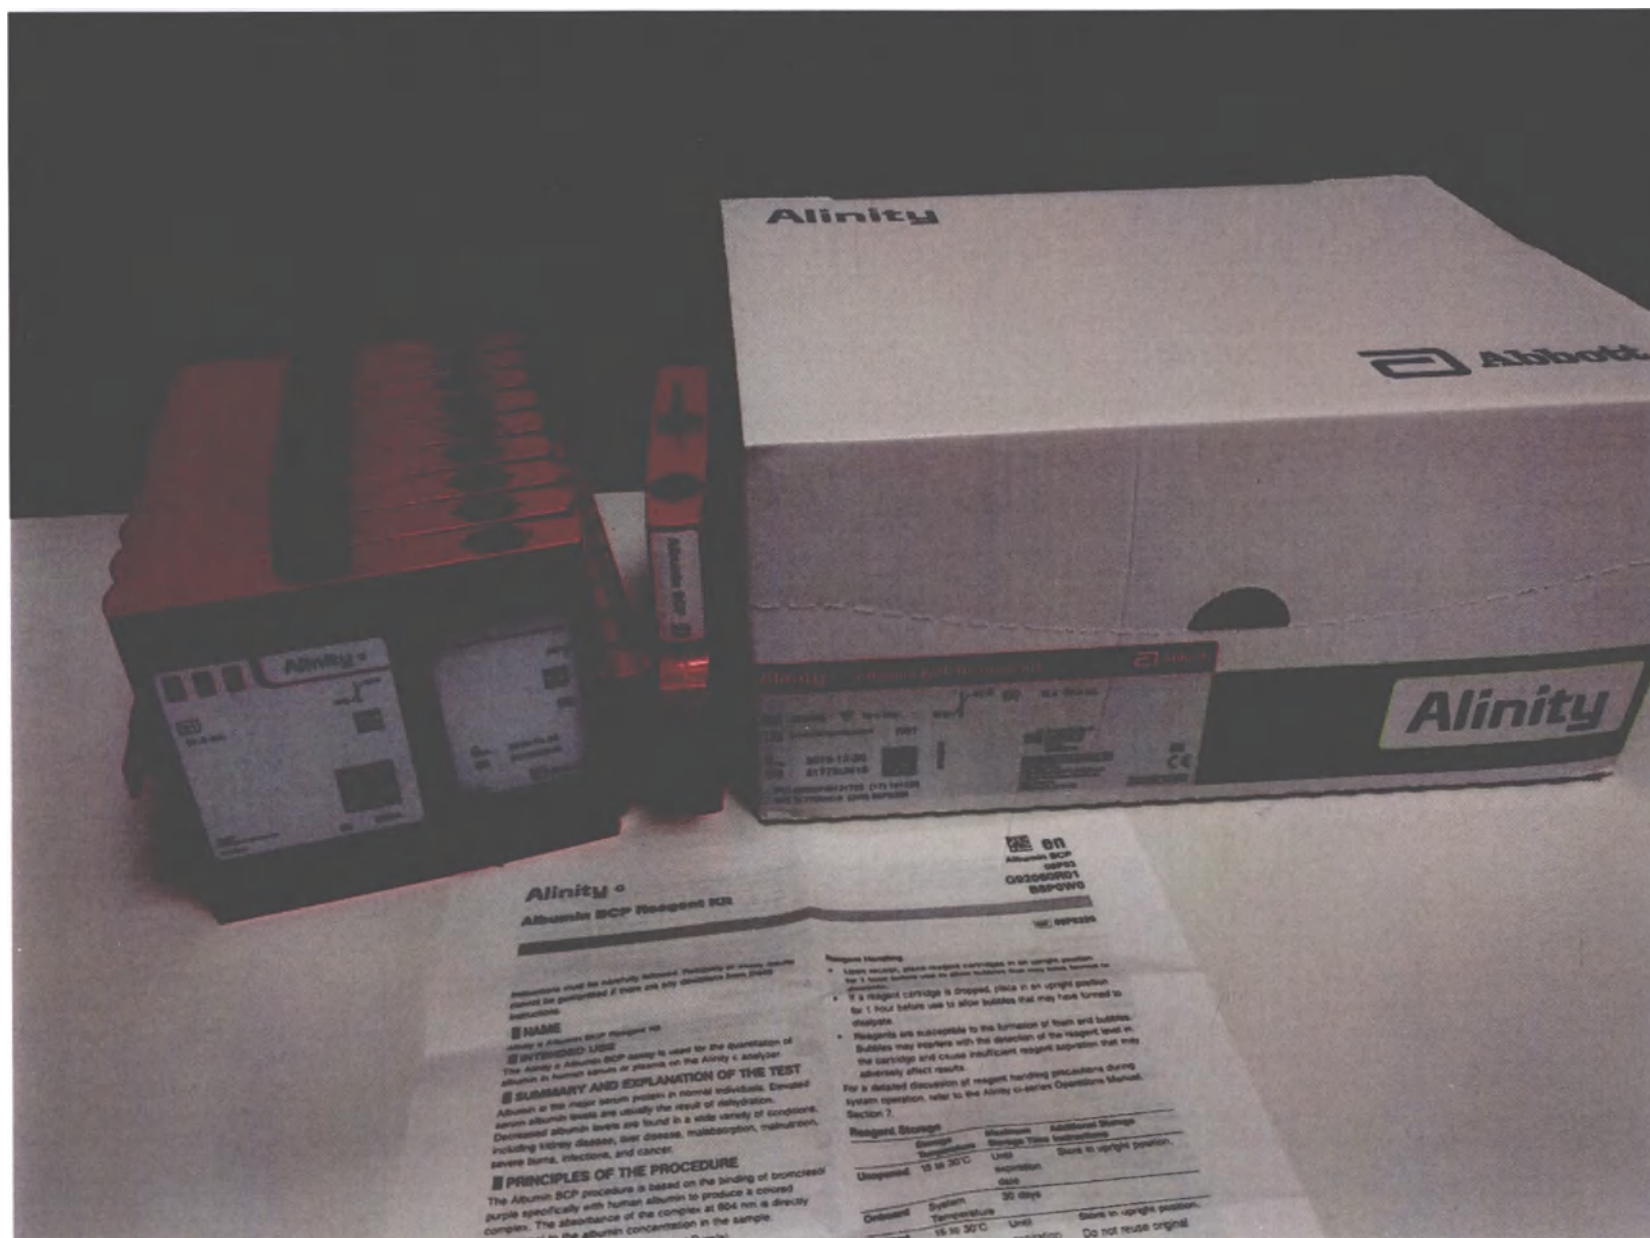

Фотографическое изображение картриджа «Alinity с Альбумин бромкрезоловый пурпурный Реагенты (Alinity с Albumin BCP Reagent Kit)»



всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

5 листов



Подпись

[Handwritten signature]

Макет маркировки на медицинское изделие

Набор реагентов для количественного определения альбумина в сыворотке или плазме крови человека колориметрическим методом с использованием бромкрезолового пурпурного на биохимических анализаторах Alinity с «Alinity с Альбумин бромкрезоловый пурпурный Реагенты (Alinity с Albumin BCP Reagent Kit)»



08P03-20



Набор реагентов для количественного определения альбумина в сыворотке или плазме крови человека колориметрическим методом с использованием бромкрезолового пурпурного на биохимических анализаторах Alinity c

«Alinity c Альбумин бромкрезоловый пурпурный Реагенты (Alinity c Albumin BCP Reagent Kit)»

10 картриджей по 345 тестов в составе: Реагент 1 (Alinity c Albumin BCP Reagent 1) – 10 x 67,6 мл; Инструкция по применению/Производитель: Abbott GmbH & Co. KG, Max-Planck-Ring 2, 65205 Wiesbaden, Germany (Германия)/Место производства: Fisher Diagnostics, A Div. of Fisher Scientific Company, LLC, A Part of Thermo Fisher Scientific, Inc., 8365 Valley Pike, Middletown VA 22645 USA (США)/ Страна происхождения: США/ РУ № ____/____ от ____/____/Инструкция по применению на русском языке: www.abbottdiagnostics.com/IFU/

Серия, использовать до, условия хранения указаны в графических символах.



Расшифровку графических символов см. в инструкции.

Авторизованный представитель изготовителя на территории России и других стран СНГ:

Общество с ограниченной ответственностью «Эбботт Лэбораториз», 125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, 16А, строение 1,
Тел: +7 (495) 258 42 70 (80); Факс: +7 (495) 258 42 71 (81)

Albumin BCP

Alinity c Albumin BCP Reagent Kit



REF 08P0320 10 x 345

www.abbottdiagnostics.com/IFU/



R1 10 x 67.6 mL

Information for USA only (R1 0057)
The Alinity c Albumin BCP assay is used for the quantitation of albumin in human serum or plasma on the Alinity c analyzer.
• (R1) Active ingredient: Bromocresol Purple (134 µmol/L)
Distributed in the USA by Abbott Laboratories, Abbott Park, IL 60064 USA


Abbott GmbH & Co. KG
Max-Planck-Ring 2
65205 Wiesbaden
Germany
+49-6122-580

PRODUCED FOR ABBOTT BY
Fisher Diagnostics,
A Div. of Fisher Scientific Company, LLC
A Part of Thermo Fisher Scientific, Inc.
8365 Valley Pike
Middletown VA 22645 USA



PRODUCT OF USA

кет маркировки блока компонентов медицинского изделия, фасовка 10 картриджей по 345
СТОВ

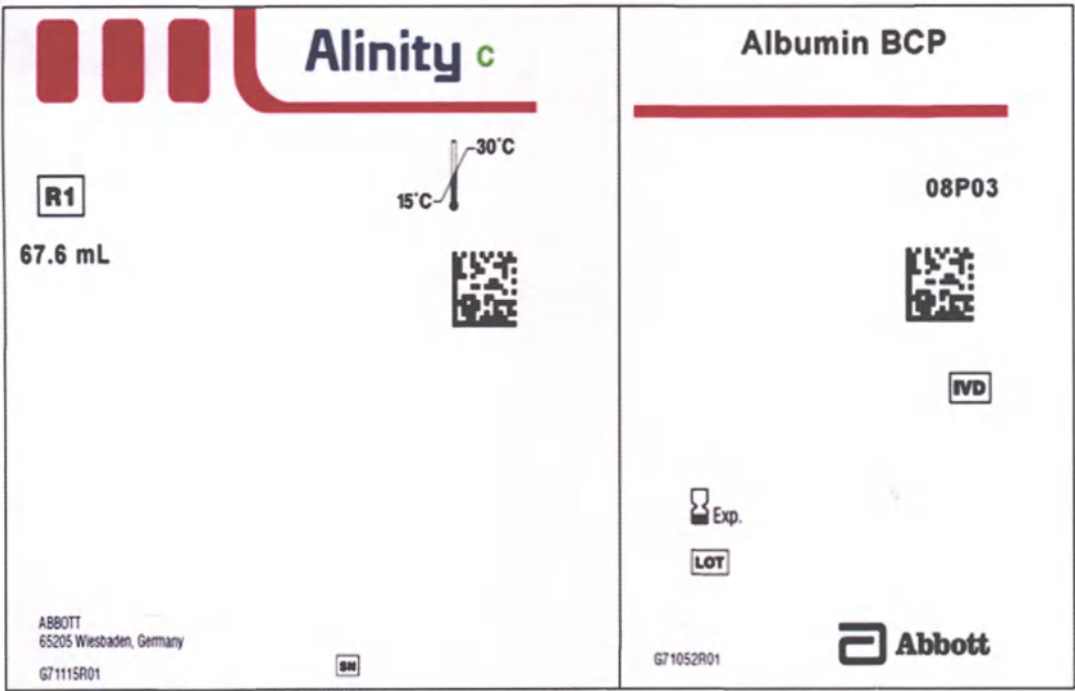

Сведения о стандартах, применяемых к этикетке на МИ:

Стандарт	Наименование стандарта
ГОСТ Р ИСО 18113-1 – 2015	Медицинские изделия для диагностики <i>in vitro</i> . Информация, предоставляемая изготовителем (маркировка). Часть 1. Термины, определения и общие требования.
ГОСТ Р ИСО 18113-2 – 2015	Медицинские изделия для диагностики <i>in vitro</i> – Информация, предоставляемая производителем (маркировка) – Часть 2: Реагенты для диагностики <i>in vitro</i> для профессионального применения.
ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014	Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации. Часть 1. Основные требования.

Расшифровка символов представлена в инструкции.

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

5 листов

