

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «ИМБИАН ЛАБ»



В.В. Осипова

«13»

июль


2022 г.

М.П.

Фотографическое изображение

Набор реагентов для иммуноферментного количественного определения иммуноглобулинов класса G (IgG) к поверхностному гликопротеину S (spike) коронавируса SARS-CoV-2 «SARS-CoV-2 IgG spike-количественный-ИМБИАН-ИФА» по ТУ 21.20.23-103-41390295-2021


Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
«SARS-CoV-2 IgG spike-количественный-ИМБИАН-ИФА»
серия 220513

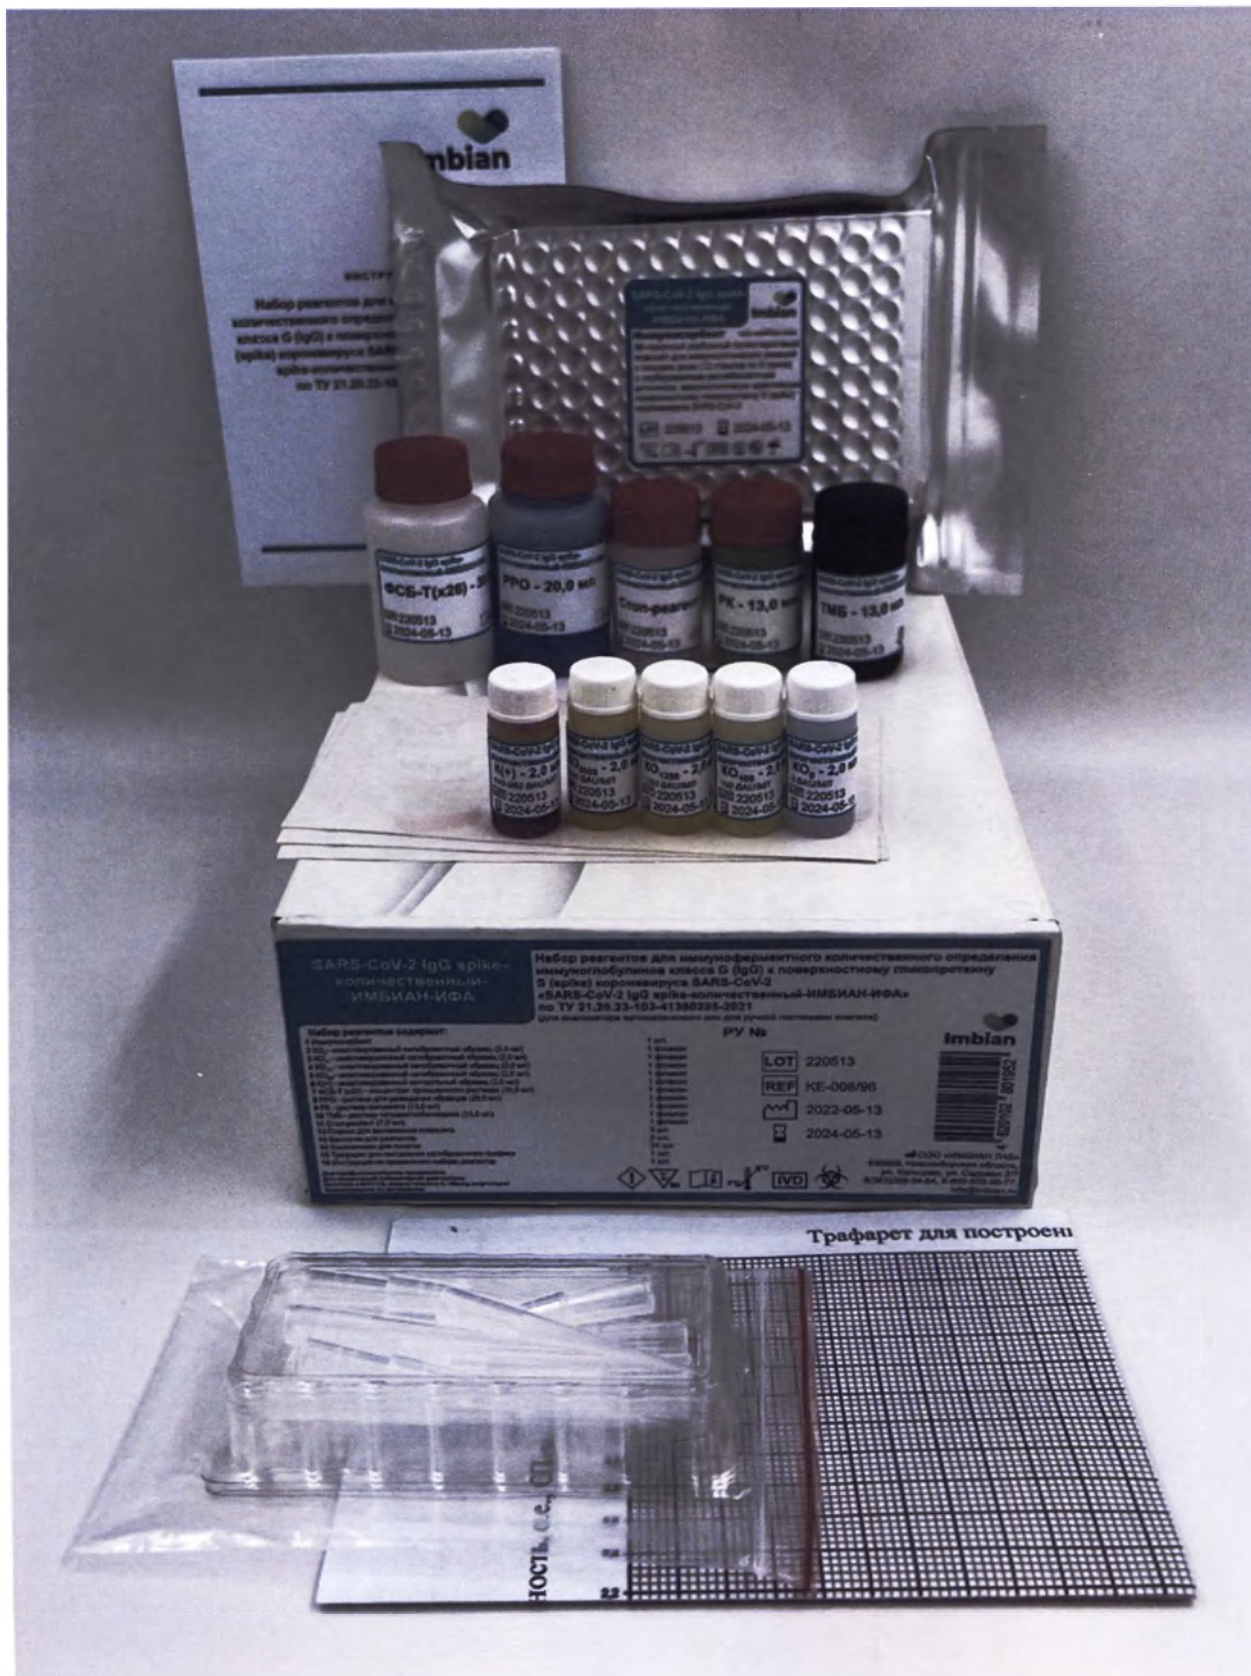

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
«SARS-CoV-2 IgG spike-количественный-ИМБИАН-ИФА»
серия 220513



Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
«SARS-CoV-2 IgG spike-количественный-ИМБИАН-ИФА»
серия 220512

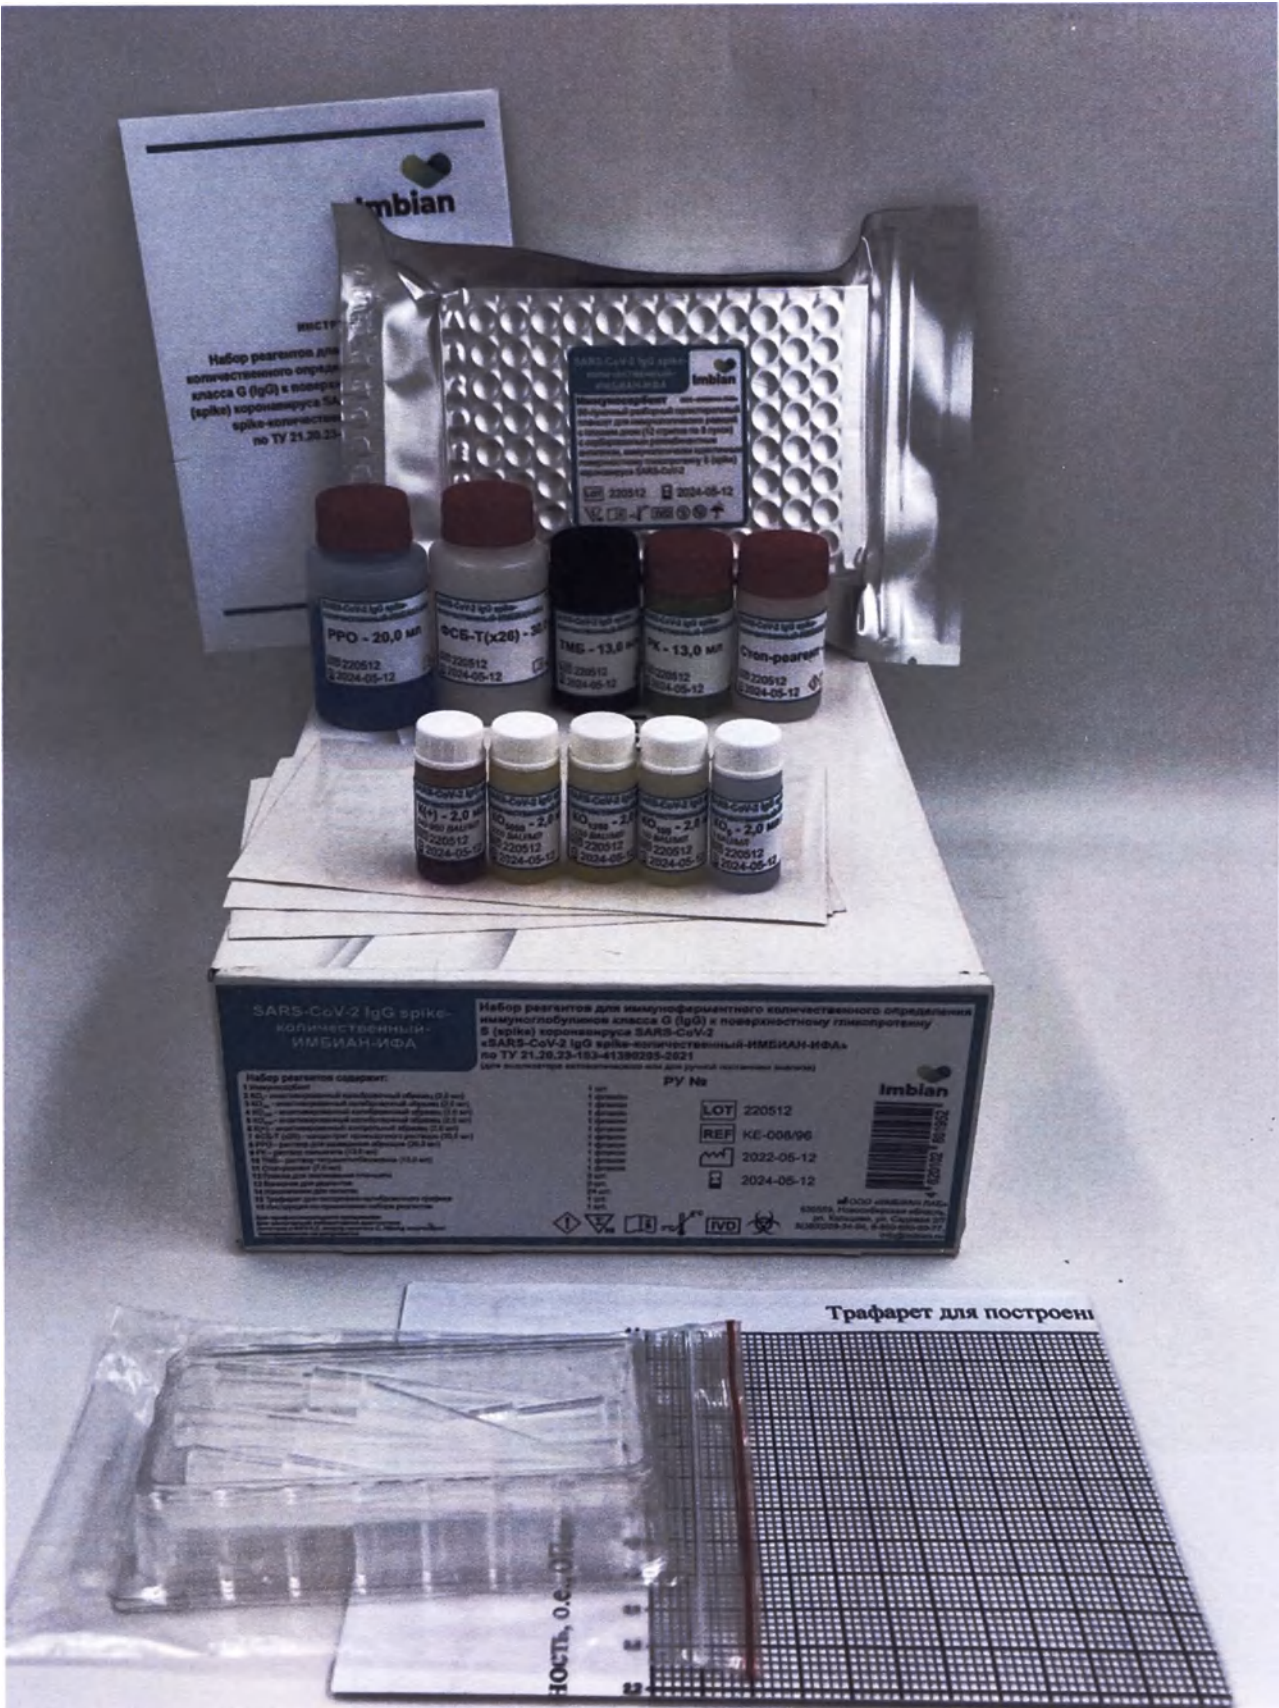

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
«SARS-CoV-2 IgG spike-количественный-ИМБИАН-ИФА»
серия 220512



Изображение основной этикетки медицинского изделия
«SARS-CoV-2 IgG spike-количественный-ИМБИАН-ИФА»
 серия 220513

**SARS-CoV-2 IgG spike-
количественный-
ИМБИАН-ИФА**

Набор реагентов содержит:

- 1 Иммуносорбент
- 2 КО₀ - инактивированный калибровочный образец (2,0 мл)
- 3 КО₁ - инактивированный калибровочный образец (2,0 мл)
- 4 КО₂ - инактивированный калибровочный образец (2,0 мл)
- 5 КО₃ - инактивированный калибровочный образец (2,0 мл)
- 6 К(+/-) - инактивированный контрольный образец (2,0 мл)
- 7 ФСБ-Т (x26) - концентрат промывочного раствора (30,0 мл)
- 8 РРО - раствор для разведения образцов (20,0 мл)
- 9 РК - раствор конъюгата (13,0 мл)
- 10 ТМБ - раствор тетраметилбензидина (13,0 мл)
- 11 Стоп-реагент (7,0 мл)
- 12 Пленка для заклеивания планшета
- 13 Ванночки для реагентов
- 14 Наконечники для пипеток
- 15 Трафарет для построения калибровочного графика
- 16 Инструкция по применению набора реагентов

Для профессионального применения
 Для клинической лабораторной диагностики
 Антитела к ВМЧ-1,2, вирусу гепатита С, HbAg отсутствуют
 Замораживание не допускается

**Набор реагентов для иммуноферментного количественного определения
 иммуноглобулинов класса G (IgG) к поверхностному гликопротеину
 S (spike) коронавируса SARS-CoV-2
 «SARS-CoV-2 IgG spike-количественный-ИМБИАН-ИФА»
 по ТУ 21.20.23-103-41390295-2021**

(для анализатора автоматического или для ручной постановки анализа)

РУ №

LOT 220513
REF KE-008/96
 2022-05-13
 2024-05-13



ООО «ИМБИАН ЛАБ»
 630559, Новосибирская область,
 рп. Кольцово, ул. Садовая 2/7
 8(383)209-34-54, 8-800-600-90-77,
 info@imbian.ru

серия 220512

**SARS-CoV-2 IgG spike-
количественный-
ИМБИАН-ИФА**

Набор реагентов содержит:

- 1 Иммуносорбент
- 2 КО₀ - инактивированный калибровочный образец (2,0 мл)
- 3 КО₁ - инактивированный калибровочный образец (2,0 мл)
- 4 КО₂ - инактивированный калибровочный образец (2,0 мл)
- 5 КО₃ - инактивированный калибровочный образец (2,0 мл)
- 6 К(+/-) - инактивированный контрольный образец (2,0 мл)
- 7 ФСБ-Т (x26) - концентрат промывочного раствора (30,0 мл)
- 8 РРО - раствор для разведения образцов (20,0 мл)
- 9 РК - раствор конъюгата (13,0 мл)
- 10 ТМБ - раствор тетраметилбензидина (13,0 мл)
- 11 Стоп-реагент (7,0 мл)
- 12 Пленка для заклеивания планшета
- 13 Ванночки для реагентов
- 14 Наконечники для пипеток
- 15 Трафарет для построения калибровочного графика
- 16 Инструкция по применению набора реагентов


Для профессионального применения
 Для клинической лабораторной диагностики
 Антитела к ВМЧ-1,2, вирусу гепатита С, HbAg отсутствуют
 Замораживание не допускается

**Набор реагентов для иммуноферментного количественного определения
 иммуноглобулинов класса G (IgG) к поверхностному гликопротеину
 S (spike) коронавируса SARS-CoV-2
 «SARS-CoV-2 IgG spike-количественный-ИМБИАН-ИФА»
 по ТУ 21.20.23-103-41390295-2021**

(для анализатора автоматического или для ручной постановки анализа)

РУ №

LOT 220512
REF KE-008/96
 2022-05-12
 2024-05-12



ООО «ИМБИАН ЛАБ»
 630559, Новосибирская область,
 рп. Кольцово, ул. Садовая 2/7
 8(383)209-34-54, 8-800-600-90-77,
 info@imbian.ru

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

6 лист 006

Генеральный директор
ООО «ИМБИАН ЛАБ»

В.В. Осипова

"13" 07 2022 г.

