



Н.А. Горшкова

2021 г.

**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO**

«Набор реагентов для определения тестостерона на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Testosterone II (Atellica IM TSTII))»

производства «Сиенс Хелскеа Диагностикс Инк.»,
Siemens Healthcare Diagnostics Inc., США

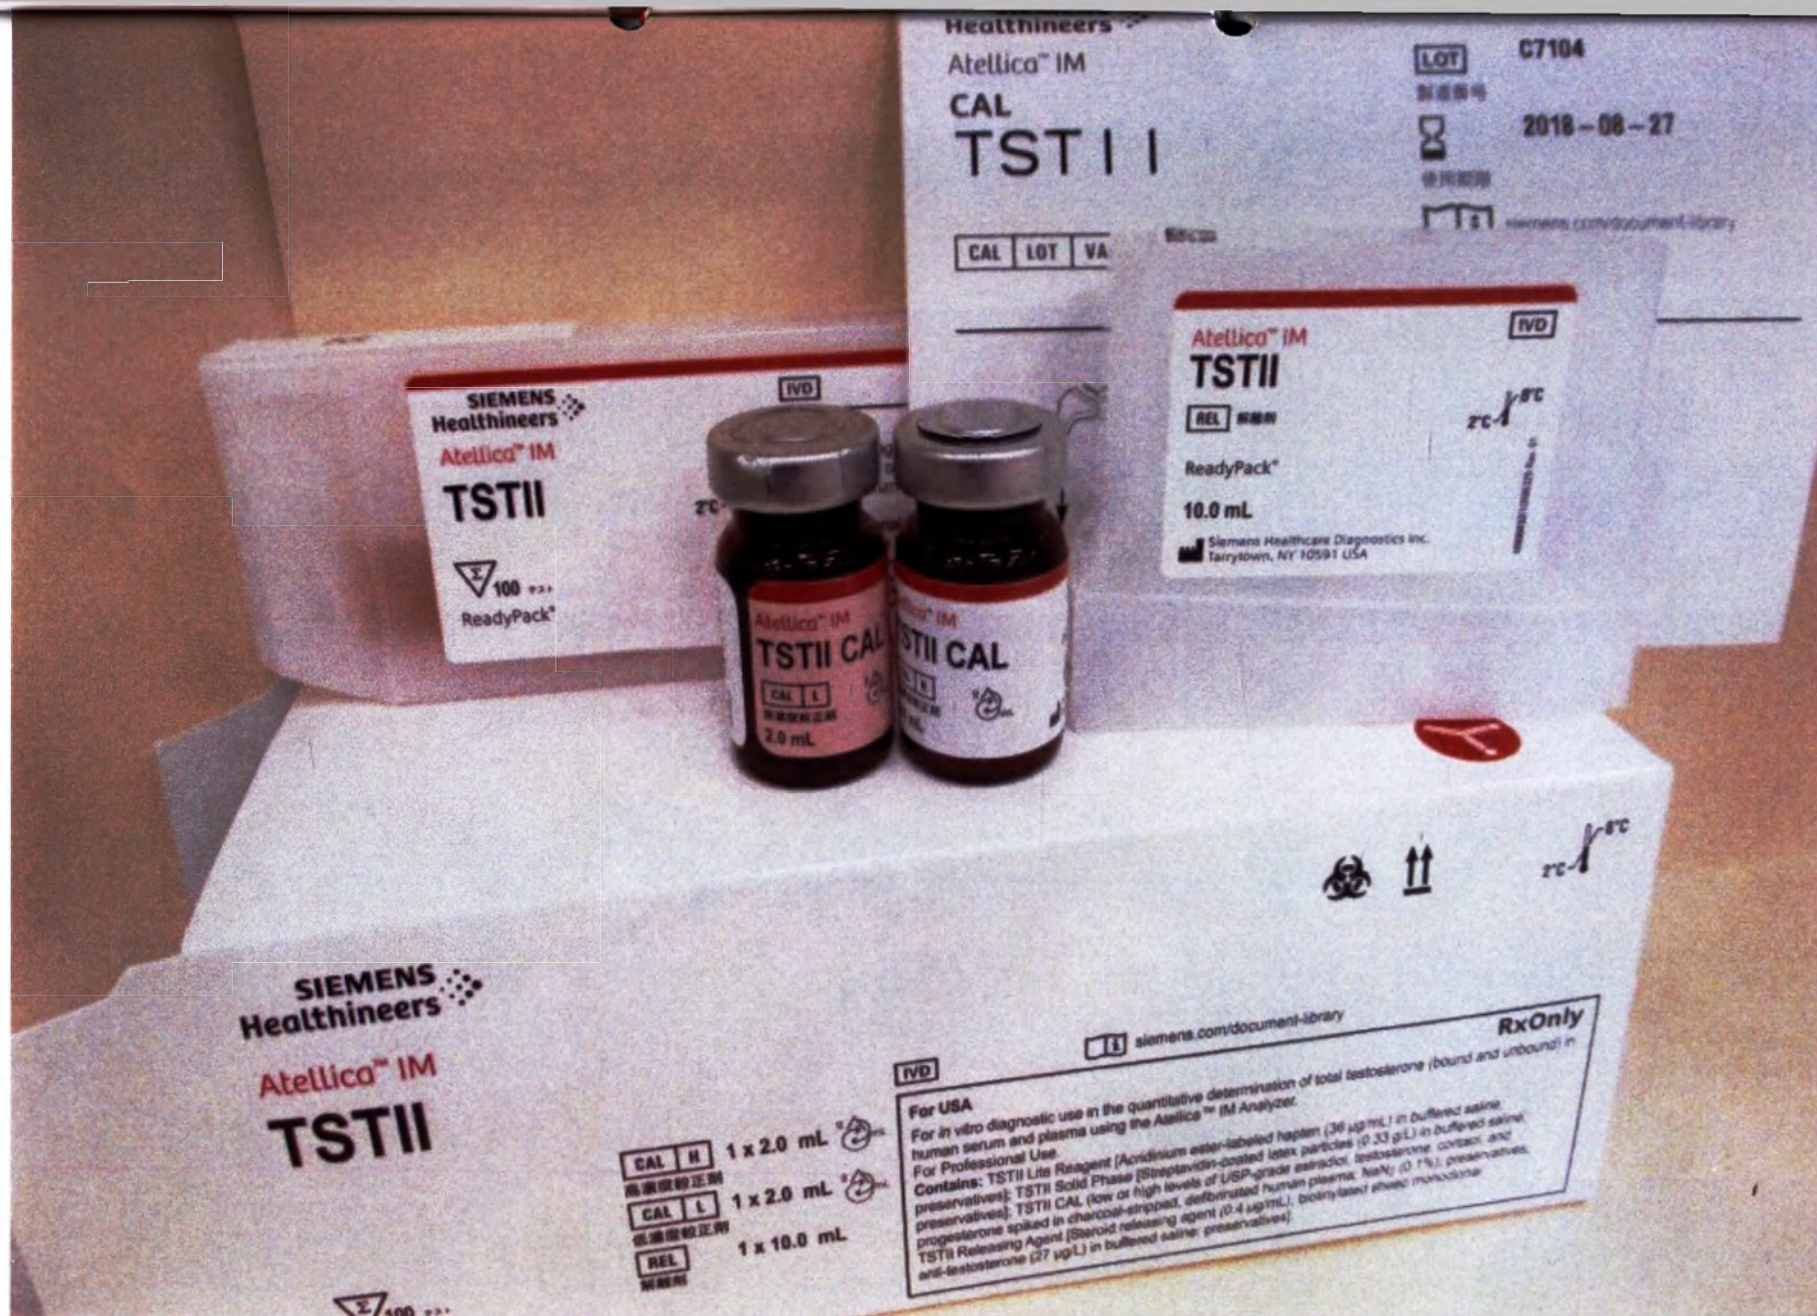


Рисунок 1. Набор реагентов для определения тестостерона на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Testosterone II (Atellica IM TSTII)). Фасовка 100 тестов. Общий вид

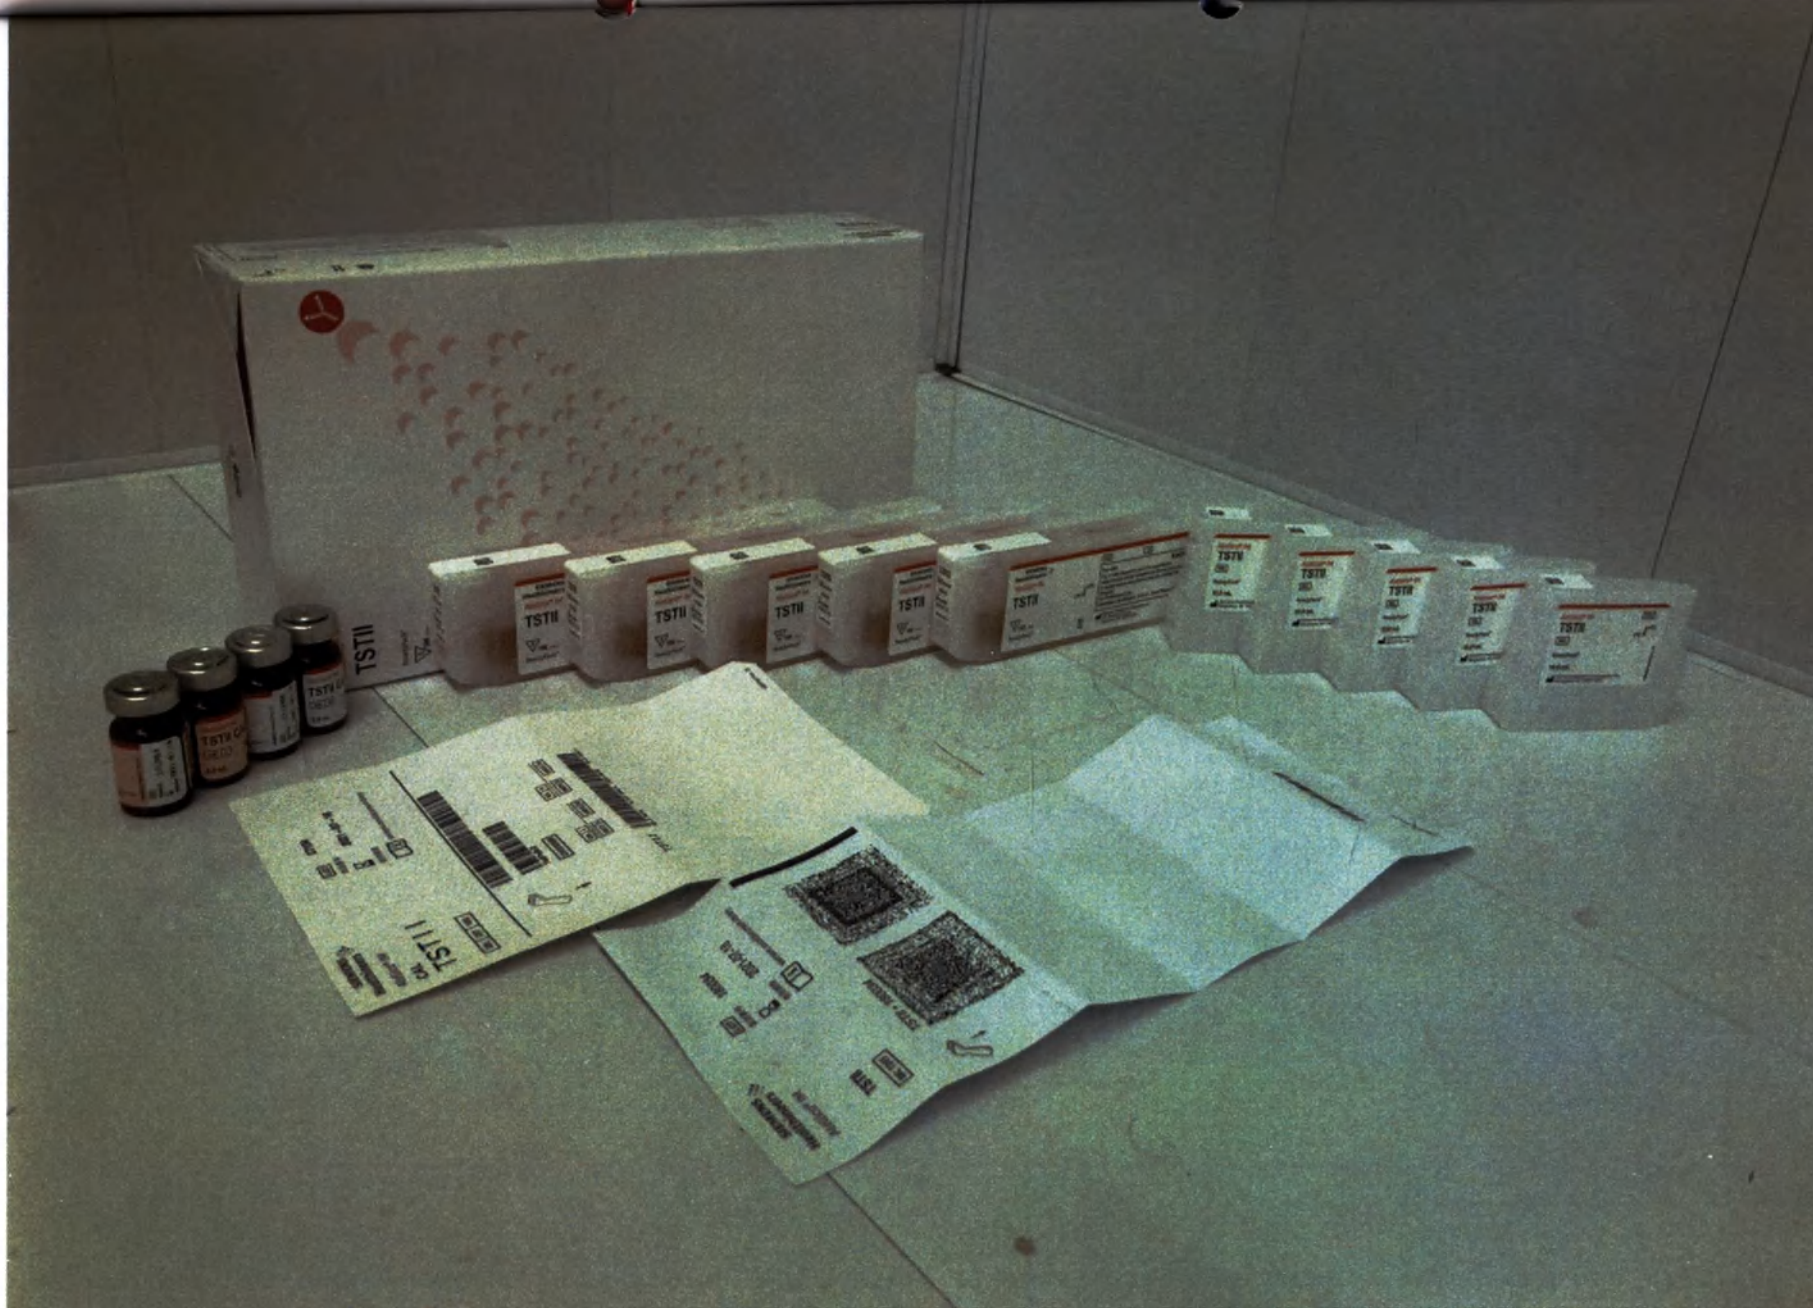


Рисунок 2. Набор реагентов для определения тестостерона на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Testosterone II (Atellica IM TSTII)). Фасовка 500 тестов. Общий вид

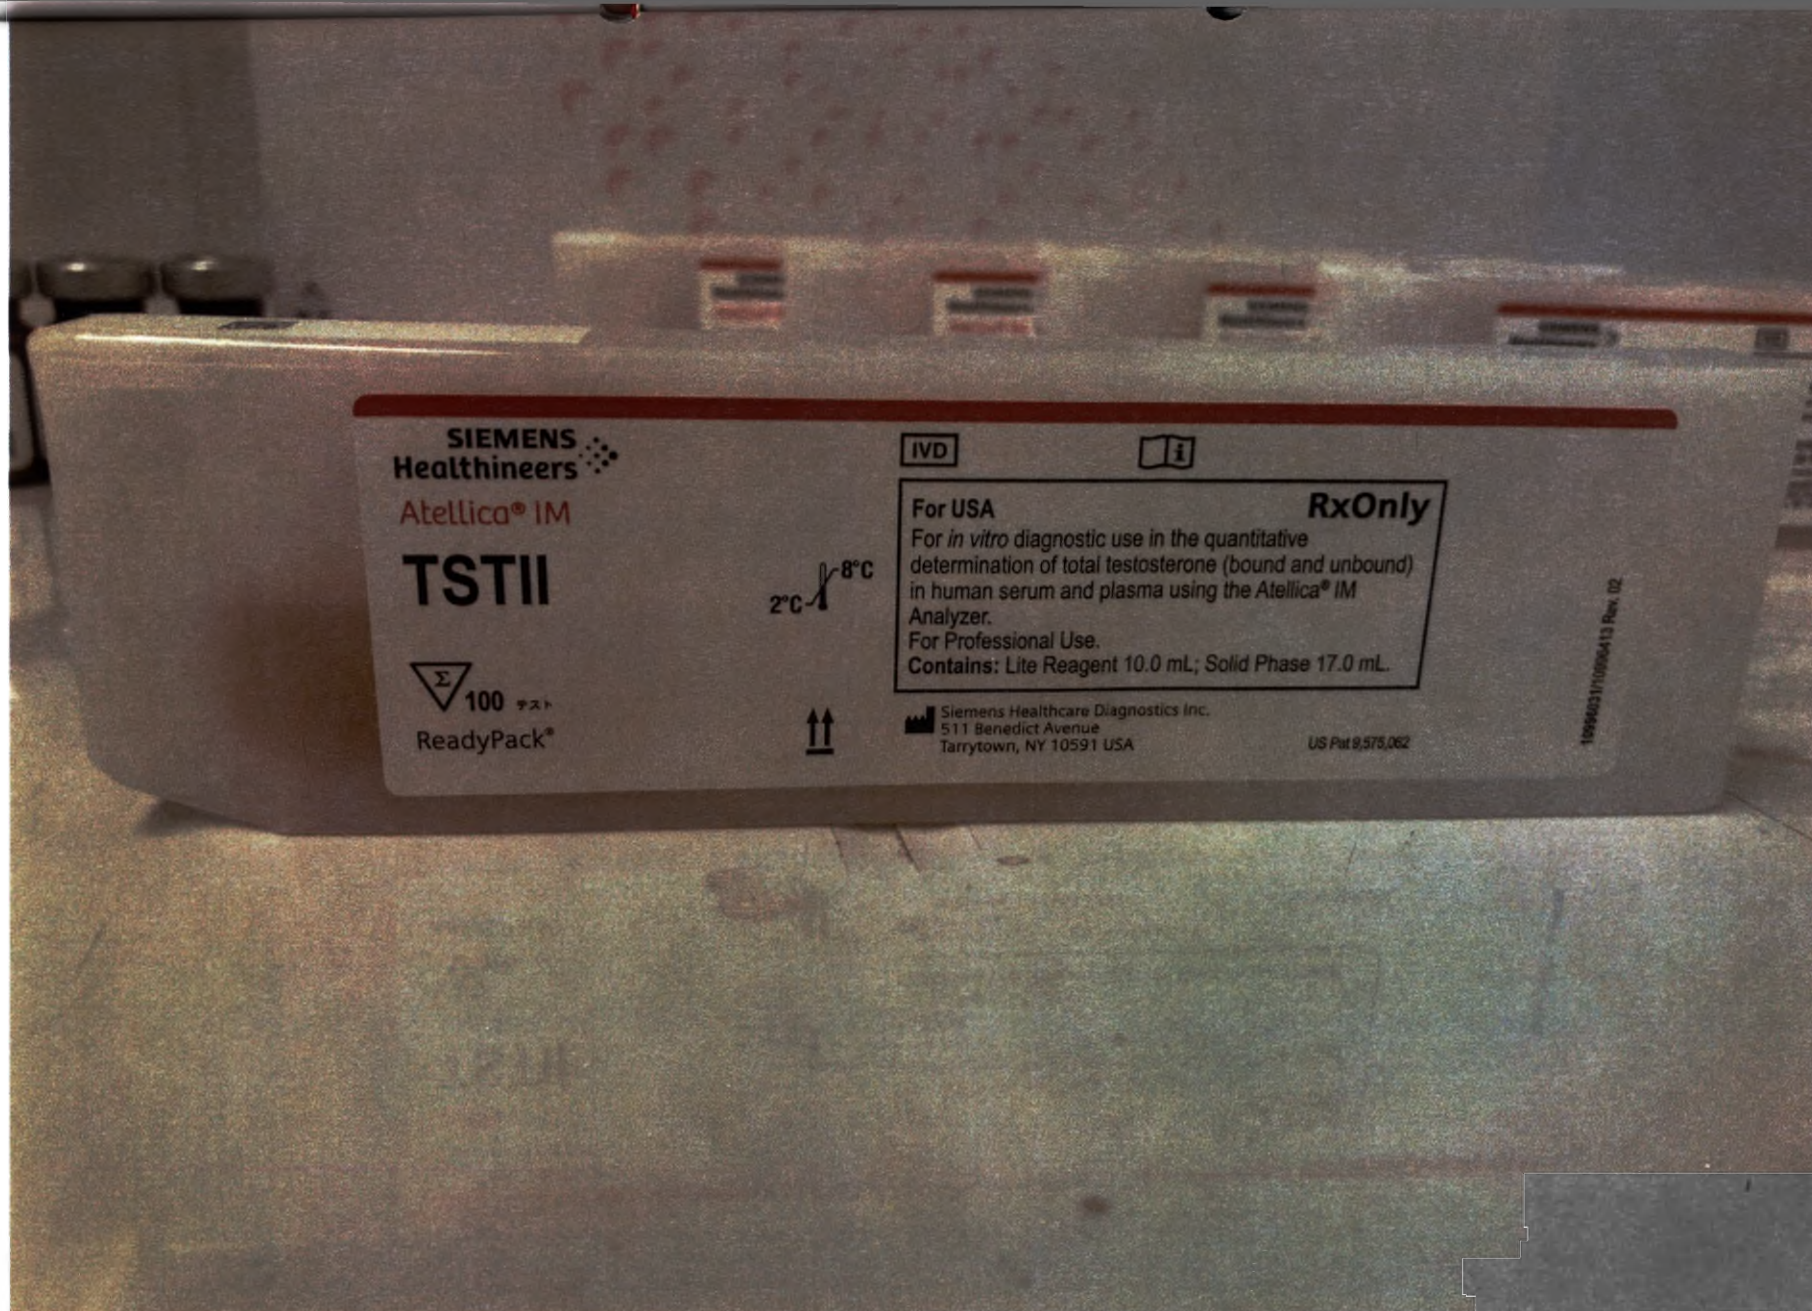


Рисунок 3. Набор реагентов для определения тестостерона на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Testosterone II (Atellica IM TSTII)): Первичный реагент Atellica IM TSTII

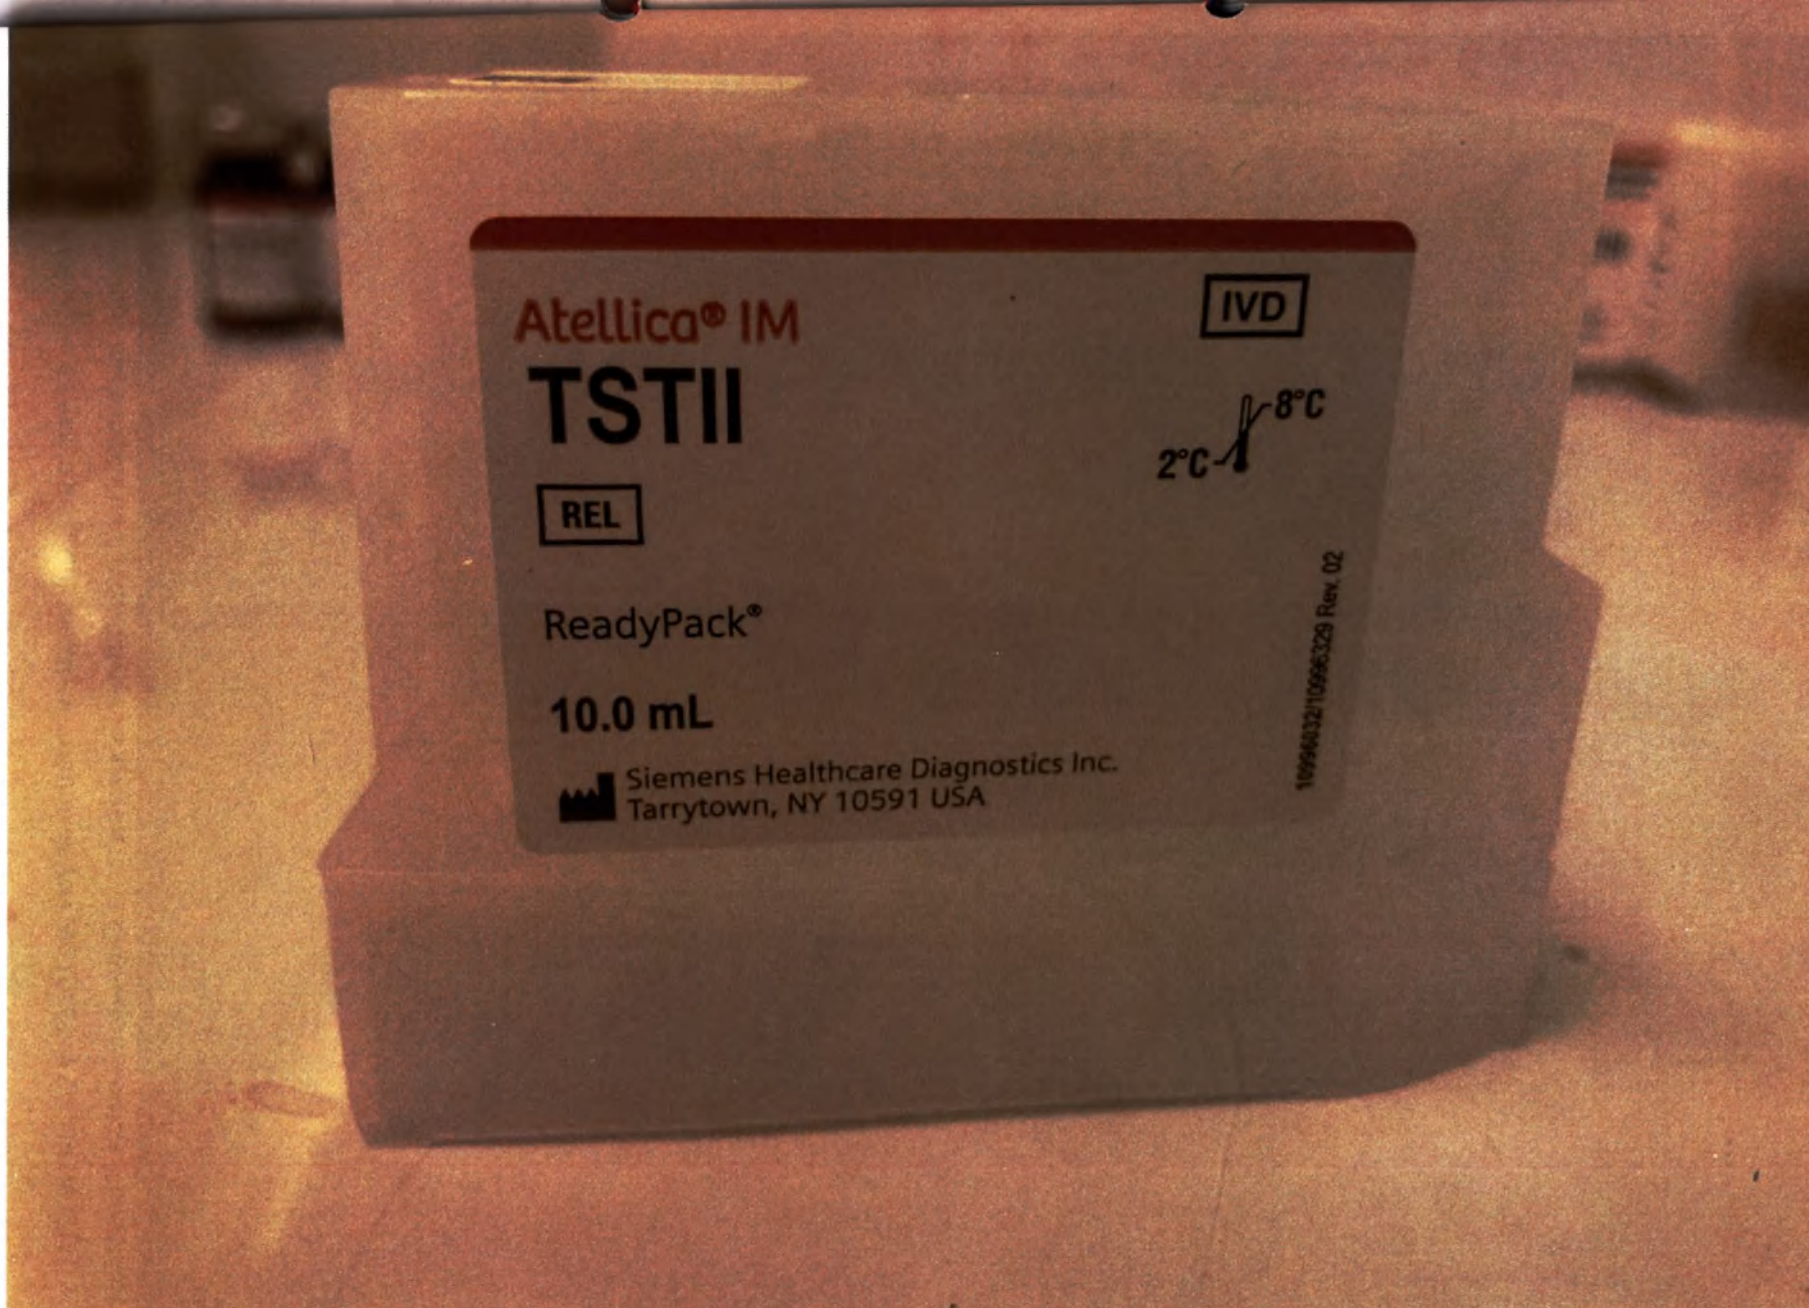


Рисунок 4. Набор реагентов для определения тестостерона на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Testosterone II (Atellica IM TSTII)): Дополнительный реагент Atellica IM TSTII

SIEMENS
Healthineers
Atellica® IM

TSTII

MC TDEF

LOT

製造番号


180034

使用期限

2021-07-18

siemens.com/document-library

TSTII • 180034



10897836 Rev. 02

Рисунок 5. Набор реагентов для определения тестостерона на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Testosterone II (Atellica IM TSTII)): Вкладыш со штрих-кодом MC TDEF для Atellica IM TSTI



Рисунок 6. Набор реагентов для определения тестостерона на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Testosterone II (Atellica IM TSTII)): Калибратор с низкой концентрацией Atellica IM TSTII CAL L, 2,0 мл



Рисунок 7. Набор реагентов для определения тестостерона на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Testosterone II (Atellica IM TSTII)): Калибратор с

высокой концентрацией Atellica IM TSTII CAL H, 2,0 мл

SIEMENS
Healthineers

Atellica® IM

CAL
TSTII

CAL LOT VAL

LOT

C7132

製造番号



2021-04-24

使用期限



[siemens.com/document-library](https://www.siemens.com/document-library)



74ea4042

CHECKSUM

CAL L

CAL R


UNITS C

UNITS SI

UNITS C

UNITS SI

TSTII



24.9 NG/DL 0.872 NMOL/L 1236 NG/DL 43.3 NMOL/L

10997540 Rev. 02

Рисунок 8. Набор реагентов для определения тестостерона на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Testosterone II (Atellica IM TSTII)): Лист значений параметров серии калибратор

Всего прошито и пронумеровано
9 листа (ов).

ООО «Сименс Здравоохранение»

