



Н.А. Горшкова

2021 г.

**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO**

«Мульти-Дилуент 3 для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Multi-Diluent 3)»

производства «Сименс Хелскеа Диагностикас Инк.»,
Siemens Healthcare Diagnostics Inc., США



Рисунок 1. Мульти-Дилуент 3 для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Multi-Diluent 3). Общий вид

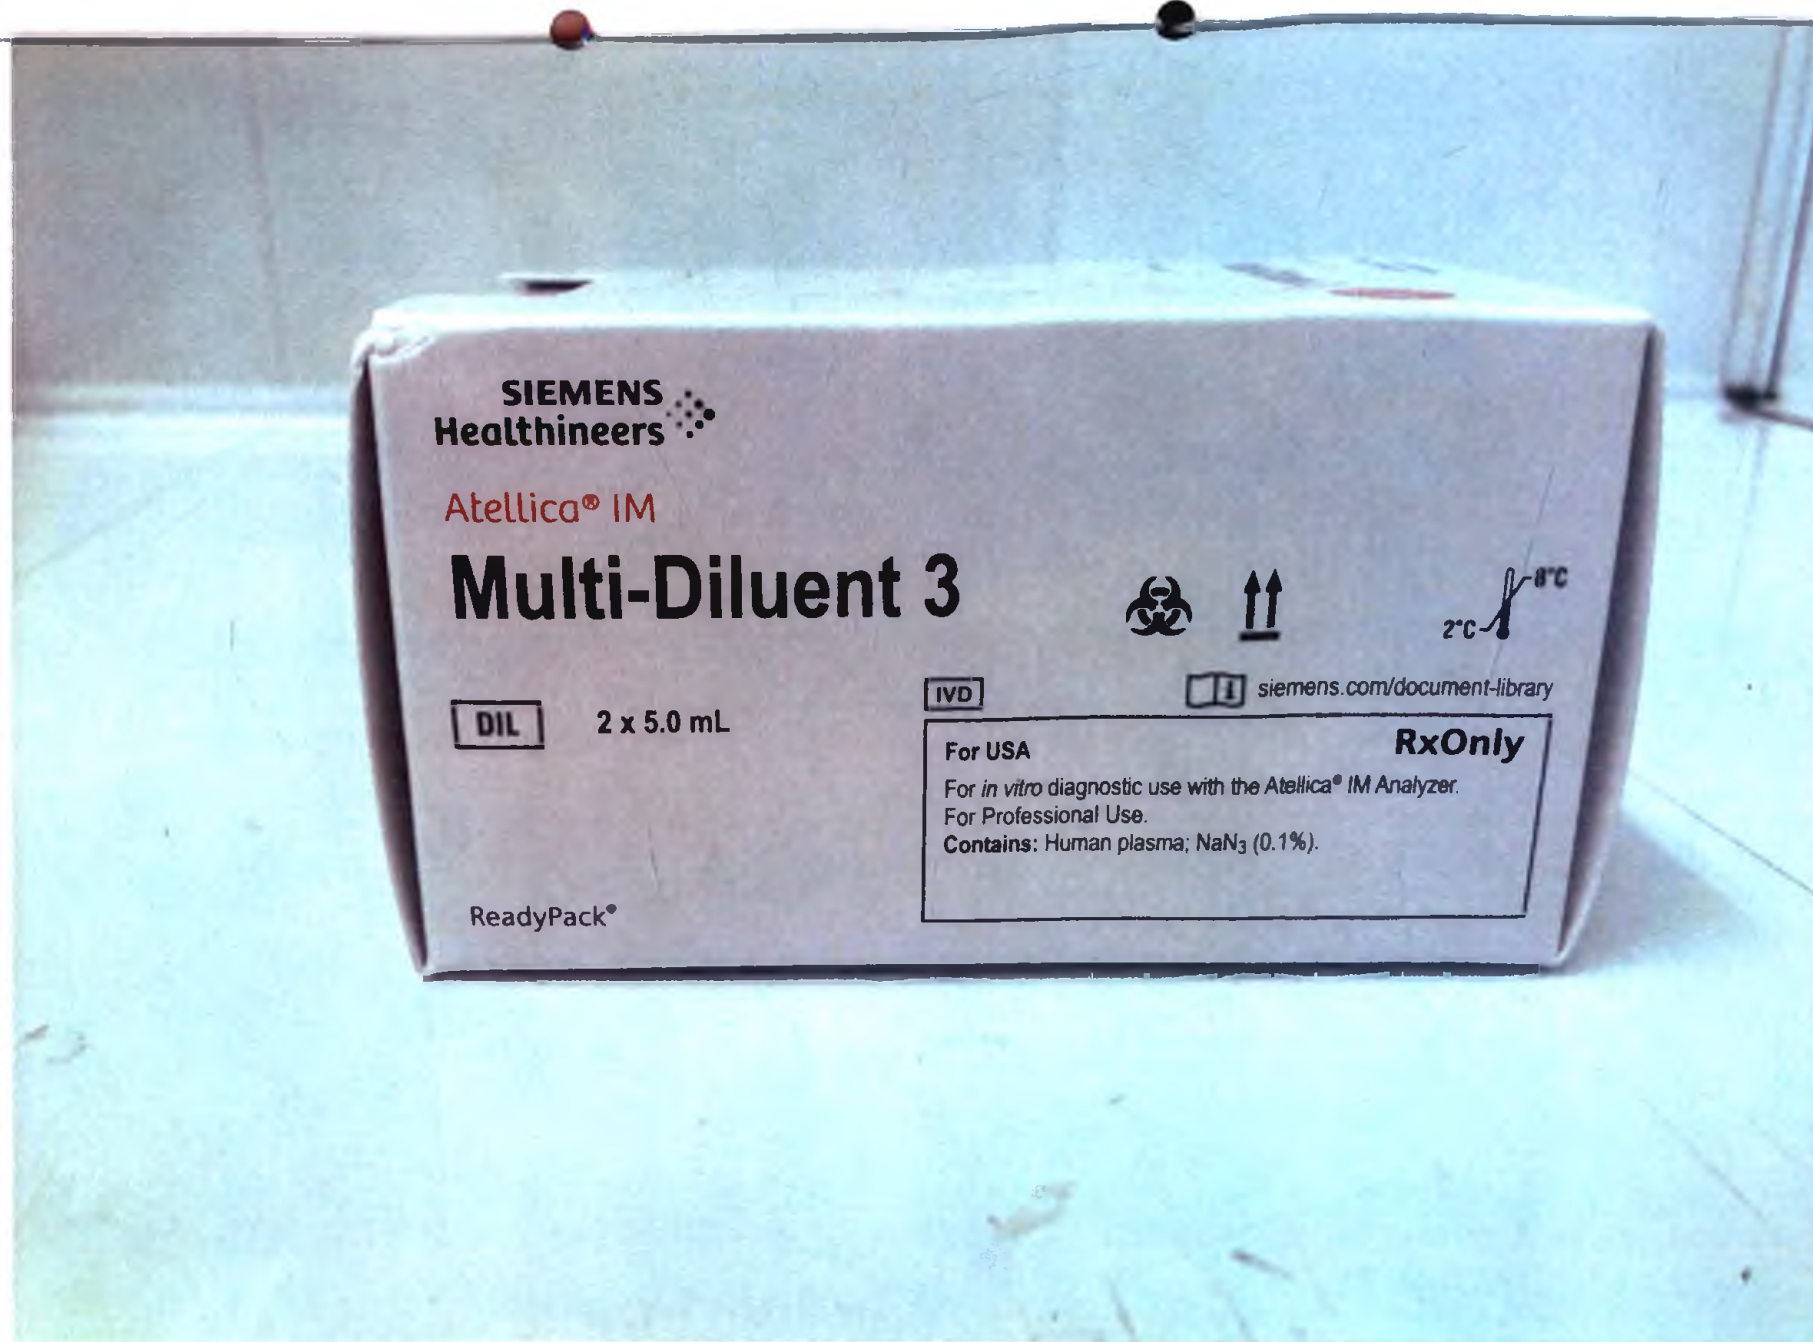


Рисунок 2. Мульти-Дилуент 3 для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Multi-Diluent 3). Общий вид



Рисунок 3. Мульти-Дилуент 3 для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Multi-Diluent 3). Общий вид

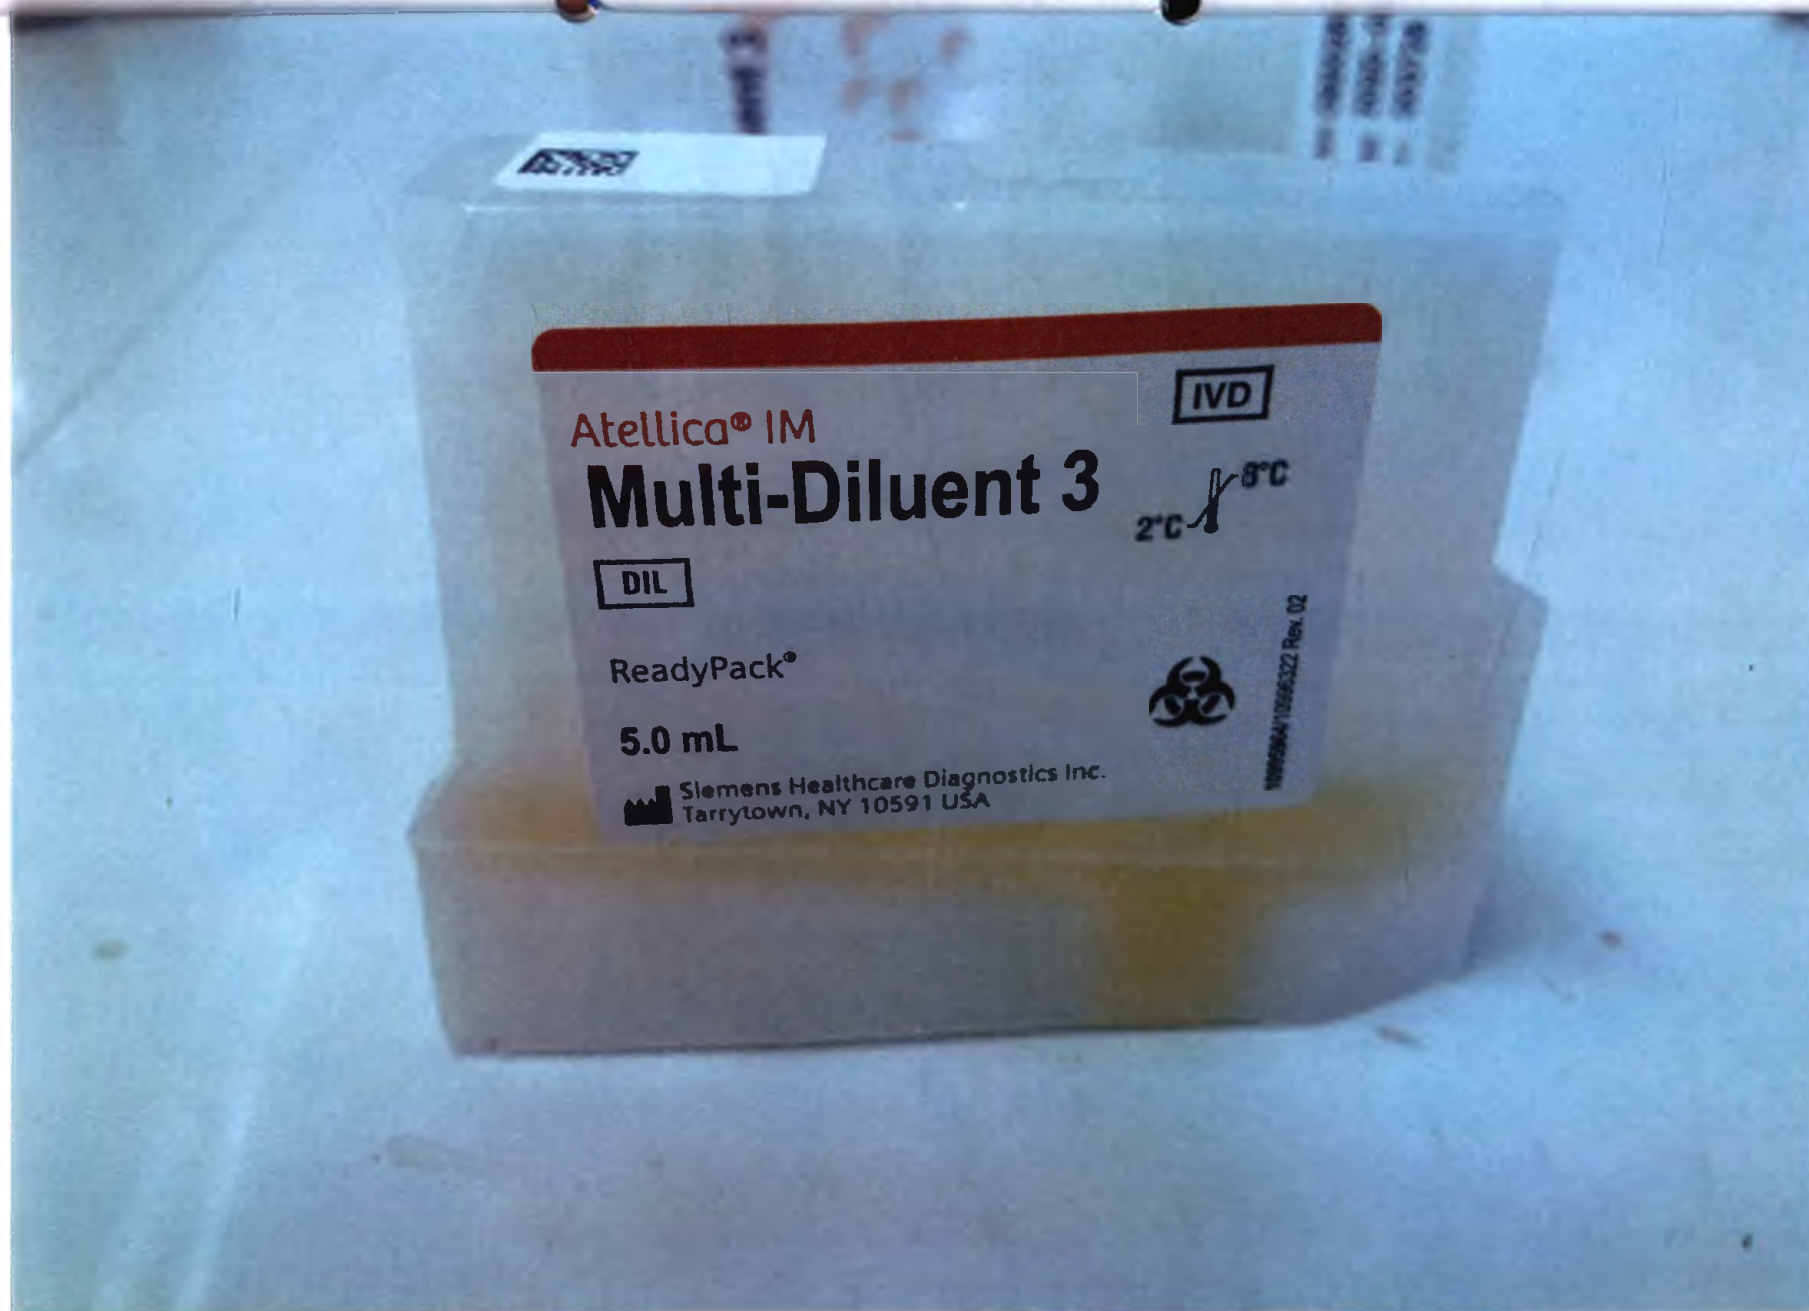


Рисунок 4. Мульти-Дилуент 3 для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Multi-Diluent 3): 1. Мульти-Дилуент 3 (Atellica IM Multi-Diluent 3) – 5,0

мл/упаковка



Всего прошито и пронумеровано
5 листа (ов).

ООО «Сименс Здоровоохранение»

