

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ВИВО МЕДИКАЛ ТЕХНОЛОДЖИС»

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «ВМТ»



Д.И. Рымбаковский

2020 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
медицинского изделия

**НАБОРЫ ДЛЯ КАТЕТЕРИЗАЦИИ СОСУДОВ НОВОРОЖДЕННОГО
«ВИВОЛАЙН»
СТЕРИЛЬНЫЕ, ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
ПО ТУ 32.50.13-001-34161832-2019**

производства: Общества с ограниченной ответственностью
«ВИВО МЕДИКАЛ ТЕХНОЛОДЖИС»

2020

Наименование медицинского изделия (с указанием принадлежностей, необходимых для применения медицинского изделия по назначению)

Наборы для катетеризации сосудов новорожденного «Виволайн» стерильные, однократного применения по ТУ 32.50.13-001-34161832-2019, варианты исполнения:

1) Набор для катетеризации сосудов новорожденного «Виволайн ПС» 1F/28G, NC-SP28S(B) стерильный, однократного применения по ТУ 32.50.13-001-34161832-2019 в составе:
- Катетер венозный центральный, одноканальный, рентгеноконтрастный, полиуретановый, с наружным диаметром 0,30 мм (1 Fr), с эффективной длиной 28 см, со стилетом - 1 шт.
- Игла расщепляемая для введения катетера 0,7 × 19 мм (24 G) - 1 шт.
- Зажим - 1 шт.
- Заглушка винтовая съёмная - 1 шт.
- Лента измерительная - 1 шт.
- Инструкция по применению - 1 шт.

2) Набор для катетеризации сосудов новорожденного «Виволайн ПС» 1F/28G, NC-SP28S(O) стерильный, однократного применения по ТУ 32.50.13-001-34161832-2019 в составе:
- Катетер венозный центральный, одноканальный, рентгеноконтрастный, полиуретановый, с наружным диаметром 0,30 мм (1 Fr), с эффективной длиной 28 см, со стилетом - 1 шт.
- Катетер внутрисосудистый периферический расщепляемый 1,1 × 25 мм (22 G) - 1 шт.
- Зажим - 1 шт.
- Заглушка винтовая съёмная - 1 шт.
- Лента измерительная - 1 шт.
- Инструкция по применению - 1 шт.

3) Набор для катетеризации сосудов новорожденного «Виволайн ПС» 1F/28G, NC-SP28S(CI) стерильный, однократного применения по ТУ 32.50.13-001-34161832-2019 в составе:
- Катетер венозный центральный, одноканальный, рентгеноконтрастный, полиуретановый, с наружным диаметром 0,30 мм (1 Fr), с эффективной длиной 28 см, со стилетом - 1 шт.
- Катетер внутрисосудистый периферический полиуретановый 0,7 × 19 мм (24 G) - 1 шт.
- Зажим - 1 шт.
- Заглушка винтовая съёмная - 1 шт.
- Лента измерительная - 1 шт.
- Инструкция по применению - 1 шт.

4) Набор для катетеризации сосудов новорожденного «Виволайн ПС» 1F/28G, NC-SP28S(CN) стерильный, однократного применения по ТУ 32.50.13-001-34161832-2019 в составе:
- Катетер венозный центральный, одноканальный, рентгеноконтрастный, полиуретановый, с наружным диаметром 0,30 мм (1 Fr), с эффективной длиной 28 см, со стилетом - 1 шт.
- Катетер внутрисосудистый периферический ПТФЭ 0,7 × 19 мм (24 G) - 1 шт.
- Зажим - 1 шт.
- Заглушка винтовая съёмная - 1 шт.
- Лента измерительная - 1 шт.
- Инструкция по применению - 1 шт.

5) Набор для катетеризации сосудов новорожденного «Виволайн ПС» 1F/28G, NC-SP28S(CNM) стерильный, однократного применения по ТУ 32.50.13-001-34161832-2019 в составе:
- Катетер венозный центральный, одноканальный, рентгеноконтрастный, полиуретановый, с наружным диаметром 0,30 мм (1 Fr), с эффективной длиной 28 см, со стилетом - 1 шт.
- Катетер внутрисосудистый периферический ПТФЭ 0,6 × 19 мм (26 G) - 1 шт.
- Зажим - 1 шт.
- Заглушка винтовая съёмная - 1 шт.
- Лента измерительная - 1 шт.
- Инструкция по применению - 1 шт.

•

- Инструкция по применению - 1 шт.

























reg. n° 7 (MIL) 279 20-62 - e-mail info@viva
shop - shop@viva

[illegible]

Виволан

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

[illegible]

- 226

3











11-25 am 22G;

[illegible]

Виволани

© 1998 by Blackwell Science Ltd, *Journal of Internal Medicine* 243: 395–402

NEEDS PRODUCTION

- MC-SPT285(CJ) TV 22 56 13 001 28

Fig. 1. *Phragmites* in a natural, typical wetland of the Sacramento-San Joaquin River Delta, California. The water level was at 179 cm on 10/25/01.

RETURNS AND PERFORMANCES OF IPOs

0.7 × 19 mm (24G)

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182838485868788899091929394959697989910010110210310410510610710810911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818919019119219319419519619719819920020120220320420520620720820921021121221321421521621721821922022122222322422522622722822923023123223323423523623723823924024124224324424524624724824925025125225325425525625725825926026126226326426526626726826927027127227327427527627727827928028128228328428528628728828929029129229329429529629729829930030130230330430530630730830931031131231331431531631731831932032132232332432532632732832933033133233333433533633733833934034134234334434534634734834935035135235335435535635735835936036136236336436536636736836937037137237337437537637737837938038138238338438538638738838939039139239339439539639739839940040140240340440540640740840941041141241341441541641741841942042142242342442542642742842943043143243343443543643743843944044144244344444544644744844945045145245345445545645745845946046146246346446546646746846947047147247347447547647747847948048148248348448548648748848949049149249349449549649749849950050150250350450550650750850951051151251351451551651751851952052152252352452552652752852953053153253353453553653753853954054154254354454554654754854955055155255355455555655755855956056156256356456556656756856957057157257357457557657757857958058158258358458558658758858959059159259359459559659759859960060160260360460560660760860961061161261361461561661761861962062162262362462562662762862963063163263363463563663763863964064164264364464564664764864965065165265365465565665765865966066166266366466566666766866967067167267367467567667767867968068168268368468568668768868969069169269369469569669769869970070170270370470570670770870971071171271371471571671771871972072172272372472572672772872973073173273373473573673773873974074174274374474574674774874975075175275375475575675775875976076176276376476576676776876977077177277377477577677777877978078178278378478578678778878979079179279379479579679779879980080180280380480580680780880981081181281381481581681781881982082182282382482582682782882983083183283383483583683783883984084184284384484584684784884985085185285385485585685785885986086186286386486586686786886987087187287387487587687787887988088188288388488588688788888989089189289389489589689789889990090190290390490590690790890991091191291391491591691791891992092192292392492592692792892993093193293393493593693793893994094194294394494594694794894995095195295395495595695795895996096196296396496596696796896997097197297397497597697797897998098198298398498598698798898999099199299399499599699799899910001001100210031004100510061007100810091010101110121013101410151016101710181019102010211022102310241025102610271028102910301031103210331034103510361037103810391040104110421043104410451046104710481049105010511052105310541055105610571058105910601061106210631064106510661067106810691070107110721073107410751076107710781079108010811082108310841085108610871088108910901091109210931094109510961097109810991100110111021103110411051106110711081109111011111112111311141115111611171118111911201121112211231124112511261127112811291130113111321133113411351136113711381139114011411142114311441145114611471148114911501151115211531154115511561157115811591160116111621163116411651166116711681169117011711172117311741175117611771178117911801181118211831184118511861187118811891190119111921193119411951196119711981199120012011202120312041205120612071208120912101211121212131214121512161217121812191220122112221223122412251226122712281229123012311232123312341235123612371238123912401241124212431244124512461247124812491250125112521253125412551256125712581259126012611262126312641265126612671268126912701271127212731274127512761277127812791280128112821283128412851286128712881289129012911292129312941295129612971298129913001

 **ООО ЦИРМИ**  **INFO@CIRMI.RU**  **WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU**

Набор для катетеризации сосудов новорожденного «Виволзин ПС» 1F/28G, NC-SP285(CNM), стерильный, однократного применения по
ТУ 32.50.13.001-34161832-2019 – пример для информации маркировки с герметичной упаковкой в стерильной упаковке Упаковка Вариант 1»

Виволзин

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖИВАНИЯ

- 1. Внимательно читать инструкцию по применению.
- 2. Не использовать изделие после истечения срока годности.
- 3. Не использовать изделие после вскрытия упаковки.
- 4. Не использовать изделие после повреждения упаковки.
- 5. Не использовать изделие после повреждения изделия.

Изготовитель: ООО «Цирми», Россия, г. Москва, ул. Мухоморова, д. 30
Средства для оказания медицинской помощи

НЕТОКСИЧНО РЕНТГЕНОПРОЗРАЧНЫЙ



Набор для катетеризации сосудов новорожденного
«Виволзин ПС» 1F/28G, NC-SP285(CNM)

Стерильный, однократного применения

- 1. Изделие предназначено для катетеризации сосудов новорожденного.
- 2. Изделие предназначено для катетеризации сосудов новорожденного.
- 3. Изделие предназначено для катетеризации сосудов новорожденного.
- 4. Изделие предназначено для катетеризации сосудов новорожденного.
- 5. Изделие предназначено для катетеризации сосудов новорожденного.
- 6. Изделие предназначено для катетеризации сосудов новорожденного.
- 7. Изделие предназначено для катетеризации сосудов новорожденного.
- 8. Изделие предназначено для катетеризации сосудов новорожденного.

25.10.2022
25.10.2022
25.10.2022

05 - 0,30 mm
L - 28 cm
0,6 x 19 mm (28G)

ООО «Цирми» 127051, Москва, Гольянский проезд, д. 30
стр. 3, 3048, 3, этаж: 11, оф. 120
тел: +7 (495) 777-33-67 e-mail: info@cirmi.ru
www.cirmi.ru

Набор для катетеризации
сосудов новорожденного
«Виволзин ПС» 1F/28G,
NC-SP285(CNM)
стерильный, однократного
применения по
ТУ 32.50.13.001-34161832-
2019 – в стерильной
упаковке, вид снизу
(стерилизационная
упаковка Вариант 1)

Набор для катетеризации сосудов новорожденного «Видеакат-П» (F-28), № SP28(CN) стерильный, однократного применения по ТУ 32.50.13.001. (пример дизайна мажаста маркировки стерилизационной упаковки (стерилизационная упаковка Вариант 1))

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

Виволайн

© 1999 Blackwell Science Ltd, *Journal of Internal Medicine* 245: 391–397

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

3. Задача 1. Вывести формулы для вычисления $\Delta \sigma_{\text{ср}}$ и $\Delta \sigma_{\text{ср}}^2$ для системы с N объектами, если $\Delta \sigma_{\text{ср}}^2 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \sigma_i^2 - (\bar{\sigma})^2$.
4. Задача 2. Вывести формулы для вычисления $\Delta \sigma_{\text{ср}}$ и $\Delta \sigma_{\text{ср}}^2$ для системы с N объектами, если $\Delta \sigma_{\text{ср}}^2 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \sigma_i^2 - (\bar{\sigma})^2$.
5. Задача 3. Вывести формулы для вычисления $\Delta \sigma_{\text{ср}}$ и $\Delta \sigma_{\text{ср}}^2$ для системы с N объектами, если $\Delta \sigma_{\text{ср}}^2 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \sigma_i^2 - (\bar{\sigma})^2$.
6. Задача 4. Вывести формулы для вычисления $\Delta \sigma_{\text{ср}}$ и $\Delta \sigma_{\text{ср}}^2$ для системы с N объектами, если $\Delta \sigma_{\text{ср}}^2 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \sigma_i^2 - (\bar{\sigma})^2$.

Кремль и Голливуд: что такое кино в СССР и России
for temperature: 17.2, 17.2, 17.2
© 2007-2008 by Vladimir V. Kozlov

НЕТОКСИЧНО РЕНТГЕНОПРОЗРАЧНЫЯ



«Виволайн П» 1F/28G, NC-SP28(CN)
стерильный, однократного применения в составе

4. материал - берилловый центральный однокристалльный
центрально-симметричный полупроводниковый с малым
диаметром 0,30 мм 1×10^{18} / см³ (разорезанной длиной
0,80 мм $\pm 0,02$);
5. материал - берилловый центрально-симметричный
полупроводниковый с малым
диаметром 0,30 мм 24 Г (разорезанной длиной
0,80 мм $\pm 0,02$);
6. материал - берилловый центрально-симметричный
полупроводниковый с малым
диаметром 0,30 мм 1×10^{18} / см³ (разорезанной длиной
0,80 мм $\pm 0,02$);
7. материал - берилловый центрально-симметричный
полупроводниковый с малым
диаметром 0,30 мм 1×10^{18} / см³ (разорезанной длиной
0,80 мм $\pm 0,02$);

25/10/2022
 10:10:10

⌀ - 0.30 mm
 L - 28 cm

0,7 x 19 mm (24G)

000-888-72761 : Macaulay-Lyons Group, LLC
170 E. 3rd St. Suite 1400, St. Louis, MO 63102
Tel: +1 (888) 727-3367 e-mail: info@maculay-lyons.com
www.myls.com

Категория: **Классическая литература**

Виволайн

© 1999 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 245: 391–397

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

4. Запрещается применение любых средств, способствующих разрушению или повреждению поверхности, а также нанесению на нее каких-либо веществ.
5. Категорически запрещается использование абразивных материалов (песка, опилок, стружки, металлической стружки, стальной проволоки и т.п.) для очистки поверхности.
6. Категорически запрещается использование абразивных материалов (песка, опилок, стружки, металлической стружки, стальной проволоки и т.п.) для очистки поверхности.
7. Категорически запрещается использование абразивных материалов (песка, опилок, стружки, металлической стружки, стальной проволоки и т.п.) для очистки поверхности.

Характеристики: $\gamma = 1,4$; $\mu = 0,001$; $\sigma = 0,001$; $\sigma_{\text{max}} = 0,001$
 Идентификация: $\gamma = 1,4$; $\mu = 0,001$; $\sigma = 0,001$; $\sigma_{\text{max}} = 0,001$
 Идентификация: $\gamma = 1,4$; $\mu = 0,001$; $\sigma = 0,001$; $\sigma_{\text{max}} = 0,001$

НЕТОКСИЧНО РЕНТГЕНОПРОЗРАЧНЫЙ



набор для катетеризации сосудов новорожденного
«Виволайн ПС» 1F/28G, NC-SP28S(O)
 стерильный, однократного применения в составе

- [illegible]

 PDF
 MFL
 LST

Ø - 0,30 mm
L - 28 cm

1,1 x 25 mm (22G)

ООО «БВТ» 127061 г. Москва, Бутырская Цирковой д. 30,
 этаж 3, комната 14, каб. 329
 тел. +7 (495) 777-33-87 e-mail: info@bvt.ru
 сайт: bvt.ru

Набор для характеристики структуры выраженного – Виноград HC = 21–240; NC: SP28M (1) стероидный, однократный, применен по 15–40, 50–100; 2019 – пример для области маркировки стереотипичной упаковки (стероидичность упаковки, Вариант 2)

NAME OF THE PARTY: (Print name of the party in full)

Виволайн

Journal of Management Education 30(6)p.789-801

$$M(\text{Pb}) = 206.974 \text{ g mol}^{-1}, T_{\text{melt}} = 327.3^\circ \text{C}$$

- а) $\frac{1}{2} \ln \frac{1}{2} \ln \frac{1}{2}$
или $\frac{1}{2} \ln \frac{1}{2} \ln \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \ln \frac{1}{2} \ln \frac{1}{2}$
- б) Категорична е идеологията на
 $\frac{1}{2} \ln \frac{1}{2} \ln \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \ln \frac{1}{2} \ln \frac{1}{2}$
- в) Категорична е идеологията на
обичайния човек: $\frac{1}{2} \ln \frac{1}{2} \ln \frac{1}{2}$
- г) Персонална идеология на човек, който
е тежко болен: $\frac{1}{2} \ln \frac{1}{2} \ln \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \ln \frac{1}{2} \ln \frac{1}{2}$

[illegible]

НЕТОКСИЧНО РЕНТГЕНОПРОЗРАЧНЫМ



«Виволант ПС» ZF/24G, NC-SP28S(CI)
 Специальный синтетический препарат для применения в составе

4. Fe^{2+} 100% Fe^{3+} 0% Fe^{4+} 0% Fe^{5+} 0%
 5. Fe^{2+} 100% Fe^{3+} 0% Fe^{4+} 0% Fe^{5+} 0%
 6. Fe^{2+} 100% Fe^{3+} 0% Fe^{4+} 0% Fe^{5+} 0%
 7. Fe^{2+} 100% Fe^{3+} 0% Fe^{4+} 0% Fe^{5+} 0%
 8. Fe^{2+} 100% Fe^{3+} 0% Fe^{4+} 0% Fe^{5+} 0%
 9. Fe^{2+} 100% Fe^{3+} 0% Fe^{4+} 0% Fe^{5+} 0%
 10. Fe^{2+} 100% Fe^{3+} 0% Fe^{4+} 0% Fe^{5+} 0%



Ø = 0,30 mm
L = 28 cm

1.1 x 30 mm (20G)

000-BMT-12721 - Москва, Енисейский Цирковой д. 30.
 Упр. в Моск. обл. по им. и кр. 14.06.12г
 тел. +7 (495) 777-3157 e-mail: info@mtb.ru
 website: mtb.ru

[illegible]

Виводаин

REF ID: A61716

3. $\frac{1}{2} \times 100 = 50$ (percent of total population)
4. $\frac{1}{2} \times 100 = 50$ (percent of total population)

Copyright © 2004 by John Wiley & Sons, Inc.
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without permission in writing from John Wiley & Sons, Inc.

НЕТОКСИЧНО РЕНТГЕНОПРОЗРАЧНЫЙ



• BMSOZ-14-7 2F 245 NC SP2M(O)

1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 26

— 200 —

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

• • • • •

226 .

1. *Journal of Management Studies*, 1990, 27, 1.

• • •

7-16-85-3058

25.10.2022

1.1 x 25 mm (22G)

© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 391–397

1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 26

TABLE 1

Набор для катетеризации сосудов новорожденного «Винклайн IV» – 2F-24G, NC-SP28Si(CI) с стерильной одноразовой приспосабливающейся по ТУ 32.50.13.001.14.001.2014 – пример дизайна пакета маркировки стерилизационной упаковки (стерилизационная упаковка Варежит 2)

$$I_{\text{eff}} = \frac{1}{2} \int_0^1 \left(\frac{1}{2} \left(\frac{d\psi}{dx} \right)^2 + \frac{1}{2} \left(\frac{d\psi}{dy} \right)^2 + \frac{1}{2} \left(\frac{d\psi}{dz} \right)^2 + \frac{1}{2} \left(\frac{d\psi}{dt} \right)^2 \right) dx dy dz dt$$

Виволайн

© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 395–402

[illegible]

1. $\frac{1}{2} \ln \left(\frac{1 + \sqrt{1 - 4x}}{1 - \sqrt{1 - 4x}} \right) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} x^n}{n}$
2. $\frac{1}{2} \ln \left(\frac{1 + \sqrt{1 - 4x}}{1 - \sqrt{1 - 4x}} \right) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} x^n}{n}$
3. $\frac{1}{2} \ln \left(\frac{1 + \sqrt{1 - 4x}}{1 - \sqrt{1 - 4x}} \right) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} x^n}{n}$
4. $\frac{1}{2} \ln \left(\frac{1 + \sqrt{1 - 4x}}{1 - \sqrt{1 - 4x}} \right) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} x^n}{n}$
5. $\frac{1}{2} \ln \left(\frac{1 + \sqrt{1 - 4x}}{1 - \sqrt{1 - 4x}} \right) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} x^n}{n}$
6. $\frac{1}{2} \ln \left(\frac{1 + \sqrt{1 - 4x}}{1 - \sqrt{1 - 4x}} \right) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} x^n}{n}$
7. $\frac{1}{2} \ln \left(\frac{1 + \sqrt{1 - 4x}}{1 - \sqrt{1 - 4x}} \right) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} x^n}{n}$

НЕ ТОКСИЧНО РЕНТГЕНОНЕПРОЗРАЧНЫМ



«Бивололин Л» 2F/24G, NC-SP28(CI)
 «Бивололин Л» 2F/24G, NC-SP28(CI)
 «Бивололин Л» 2F/24G, NC-SP28(CI)

[illegible]

25 10 2022


$$\mathbb{S}_n = \{ \sigma \in \text{Sym}(n) : \sigma(i) \leq i, \forall i \in [n] \} \quad n \geq 0$$
 $\phi = 0.60 \text{ mm}$

L = 28 cm

1.1 x 30 mm (20G)

OOO-BMT-127361 - Minnesota Express L2betmek 3 30
 170 1 3788 2 344 1 344 14 344 125
 170 1 3788 1 17 12 67 1 344 125 344 125 344 125
 170 1 3788 1 17 12 67 1 344 125 344 125 344 125

Набор для катетеризации сосудов новорожденного «Ниволан П/Д» 21-24G, NC-3P(CT) стерильный, однократного применения по ТУ 32.50.13.001
© 2019 – пример дизайна-макета маркировки стерилизационной упаковки (стерилизационная упаковка Вариант 2)

Второй этап характеризовался тем, что

Виволайн

Центральный банк России

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- [illegible]

$\Delta_{\text{total}} = \Delta_{\text{in}} + \Delta_{\text{out}}$ $\Delta_{\text{in}} = \Delta_{\text{out}}$ $\Delta_{\text{total}} = 2\Delta_{\text{in}}$ $\Delta_{\text{total}} = 2\Delta_{\text{out}}$

НЕТОКСИЧНО РЕНТГЕНОПРОЗРАЧНЫЙ



«Виволон ПД» 2F/24G NC-DP30(CI)
стерильний, одноразовий флакончик з 0,5 мл, 1 шт.

- 4) $\text{Fe}^{2+} + 2\text{H}^+ + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Fe}^{3+} + 2\text{OH}^-$
- 5) $\text{Fe}^{2+} + 2\text{H}^+ + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Fe}^{3+} + 2\text{OH}^-$
- 6) $\text{Fe}^{2+} + 2\text{H}^+ + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Fe}^{3+} + 2\text{OH}^-$
- 7) $\text{Fe}^{2+} + 2\text{H}^+ + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Fe}^{3+} + 2\text{OH}^-$
- 8) $\text{Fe}^{2+} + 2\text{H}^+ + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Fe}^{3+} + 2\text{OH}^-$
- 9) $\text{Fe}^{2+} + 2\text{H}^+ + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Fe}^{3+} + 2\text{OH}^-$
- 10) $\text{Fe}^{2+} + 2\text{H}^+ + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Fe}^{3+} + 2\text{OH}^-$



25-10-2022



DOI: 10.1002/eqe.1303

 $\phi = 0.60 \text{ mm}$

L = 30 cm

1.1 x 30 mm (20G)

ООО «ВМТ» 770801 МСК-886 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ Д. 30
 1-й эт., стр. 3, пом. 1, к. 14 оф. 125
 тел.: +7-495-777-51-67 e-mail: info@vmt.ru
 www.vmt.ru

Например, катетеризацию сосудов для введения раствора «Нивалон С» 2F 240, NC 5530(C) стерильный, однократного применения (в ТУ 52 50 33-001-3416195-07, например, указано: «материал маркировки: стерилизационной упаковки (система пазоловая) Упаковка: Вакуум 2»).



Виволайн

Source: U.S. Environmental Protection Agency.

謝世英 1926-2000 年 9 月 2 日

НЕТОКСИЧНО РЕНТГЕНОНЕПРОЗРАЧНЫЙ



«Виверин С» 2F/24G, NC-SS30(O)
внутренний диаметр трубки 10 мм, длина 100 мм

6. $\text{H}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_3\text{O}^+ + \text{OH}^-$
 7. $\text{H}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_3\text{O}^+ + \text{OH}^-$
 8. $\text{H}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_3\text{O}^+ + \text{OH}^-$
 9. $\text{H}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_3\text{O}^+ + \text{OH}^-$
 10. $\text{H}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_3\text{O}^+ + \text{OH}^-$



25.10.2022

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112

$\lambda = 0.60 \text{ mm}$
 $L = 30 \text{ cm}$

1.1 x 25 mm (22G)

000 +BMT+ 12/2011 Moscow Embassy Ljermont 4.30
 1000 1. 1000 3. 1000 11. 1000 14. 1000 125
 1000 1. 1000 3. 1000 11. 1000 14. 1000 125
 1000 1. 1000 3. 1000 11. 1000 14. 1000 125

Набор для характеристики сосудов новорожденного: Векнайд С. В. 246, NC-8530 (1) стерильный, однократного применения по ТУ 32.50.13.001.14161851.220 (пример дизайна-макета маркировки стерилизационной упаковки стерилизационной упаковки Вариант 1)



Виволайн

© 1999 Blackwell Science Ltd, *Journal of Internal Medicine* 245: 369–375

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. $\text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \rightarrow \text{H}_2\text{CO}_3$
 $\text{H}_2\text{CO}_3 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 + \text{H}_2\text{O}$
 $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 + \text{H}_2\text{O}$
2. $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 + \text{H}_2\text{O}$
 $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 + \text{H}_2\text{O}$
3. $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 + \text{H}_2\text{O}$
 $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 + \text{H}_2\text{O}$
4. $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 + \text{H}_2\text{O}$
 $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 + \text{H}_2\text{O}$

1. $\mathbb{R}^n$ is a normed space with norm $\|x\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i|$.
 2. $\mathbb{R}^n$ is a normed space with norm $\|x\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2}$.
 3. $\mathbb{R}^n$ is a normed space with norm $\|x\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|$.

НЕТОКСИЧНО РЕНТГЕНОПРОЗРАЧНЫЙ



«Виволон С» 2F/24G, NC-SS30(CI)

1. $\frac{1}{2} \times 100 = 50$ (percentage of the population that is female)
 2. $\frac{1}{2} \times 100 = 50$ (percentage of the population that is male)
 3. $\frac{1}{2} \times 100 = 50$ (percentage of the population that is female)
 4. $\frac{1}{2} \times 100 = 50$ (percentage of the population that is male)
 5. $\frac{1}{2} \times 100 = 50$ (percentage of the population that is female)
 6. $\frac{1}{2} \times 100 = 50$ (percentage of the population that is male)



References

$\phi = 0.60$ mm
L = 30 cm

1.1 = 30 mm 20G

[illegible]

Набор для катетеризации сосудов новорожденного «Виволайн С» 2F/24G, NC-SS30E(W) стерильный, однократного применения по ТУ 32.50.13.001.34161832.2019 – пример дизайна упаковки маркировки стерилизационной упаковки (стерилизационная упаковка Вариант 2)

Виволайн

стерильный, однократного применения

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

1. Запрещается повторное введение, частично, или полностью вышедшей иглы периферического внутрисосудистого катетера!

2. Категорически запрещается извлекать катетер обратно через иглу и периферический катетер!

3. Категорически запрещается использовать шприцы объемом менее 10 мл.

4. Перед использованием набор рекомендуется складывать в тень на 15 мин. при температуре от 0 до +5 С.

5. Хранить в темном, сухом, вентилируемом помещении при температуре от +15 С до +25 С и относительной влажности не выше 60 %.

6. Не использовать набор после истечения срока годности.

7. Не использовать набор после истечения срока годности.

8. Не использовать набор после истечения срока годности.

9. Не использовать набор после истечения срока годности.

10. Не использовать набор после истечения срока годности.

11. Не использовать набор после истечения срока годности.

12. Не использовать набор после истечения срока годности.

13. Не использовать набор после истечения срока годности.

14. Не использовать набор после истечения срока годности.

15. Не использовать набор после истечения срока годности.

16. Не использовать набор после истечения срока годности.

17. Не использовать набор после истечения срока годности.

18. Не использовать набор после истечения срока годности.

19. Не использовать набор после истечения срока годности.

20. Не использовать набор после истечения срока годности.

21. Не использовать набор после истечения срока годности.

22. Не использовать набор после истечения срока годности.

23. Не использовать набор после истечения срока годности.

24. Не использовать набор после истечения срока годности.

25. Не использовать набор после истечения срока годности.

26. Не использовать набор после истечения срока годности.

27. Не использовать набор после истечения срока годности.

28. Не использовать набор после истечения срока годности.

29. Не использовать набор после истечения срока годности.

30. Не использовать набор после истечения срока годности.

31. Не использовать набор после истечения срока годности.

32. Не использовать набор после истечения срока годности.

33. Не использовать набор после истечения срока годности.

34. Не использовать набор после истечения срока годности.

35. Не использовать набор после истечения срока годности.

Набор для катетеризации сосудов новорожденного «Виволайн С» 2F/24G, NC-SS30E(W) стерильный, однократного применения в составе:

- Катетер венозный центральный, одноканальный, рентгеноконтрастный, полиуретановый, с наружным диаметром 0,30 мм (2 Fr), с эффективной длиной 28 см, с замком из полиуретана Батоник 22 сменный, с люминесцентной трубкой – 1 шт.
- Шприц Батоник для введения катетера 1,1 x 19 мм – 1 шт.
- Зажим – 1 шт.
- Заглушка винтовая сменная – 1 шт.
- Лента измерительная – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.

25.10.2022
Хранить в темном, сухом, вентилируемом помещении при температуре от +15 С до +25 С и относительной влажности не выше 60 %

Ø - 0,30 mm
L - 28 cm
1,1 x 19 mm (19G)

ООО «ВМТ» 127061, г. Москва, Ботанический сад, д. 30
стр. 1, этаж 3, пом. 1, ком. 14, оф. 125
тел: +7 (495) 777-33-67 e-mail: info@vmt.ru
www.vmt.ru

НАБОР ДЛЯ КАТЕТЕРИЗАЦИИ СОСУДОВ НОВОРОЖДЕННОГО



Виволайн

стерильный, однократного применения

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- 1. Запрещается повторное введение, частично, или полностью вышедшей иглы периферического внутрисосудистого катетера!
- 2. Категорически запрещается извлекать катетер обратно через иглу и периферический катетер!
- 3. Категорически запрещается использовать шприцы объемом менее 10 мл.
- 4. Перед использованием набор рекомендуется складывать в тень на 15 мин. при температуре от 0 до +5 С.

Хранить в темном, сухом, вентилируемом помещении при температуре от +15 С до +25 С и относительной влажности не выше 60 %


НЕТОКСИЧНО РЕНТГЕНОНЕПРОЗРАЧНЫЙ



Набор для катетеризации сосудов новорожденного «Виволайн ПС» 1F/28G, NC-SP28S(CN) стерильный, однократного применения в составе:

- Катетер венозный центральный, одноканальный, рентгеноконтрастный, полиуретановый, с наружным диаметром 0,30 мм (1 Fr), с эффективной длиной 28 см, со стилетом – 1 шт.
- Катетер внутрисосудистый периферический ПТФЭ 0,7 x 19 мм (24 G) – 1 шт.
- Зажим – 1 шт.
- Заглушка винтовая сменная – 1 шт.
- Лента измерительная – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.

25.10.2019 25.10.2022
NC-SP28S(CN) ТУ 32.50.13.001.34161832.2019
LOT: 10251019 RU № РЗН 00000000 от 00.00.00



ООО «ВМТ» 127061, г. Москва, Ботанический сад, д. 30
стр. 1, этаж 3, пом. 1, ком. 14, оф. 125
тел: +7 (495) 777-33-67 e-mail: info@vmt.ru
www.vmt.ru

Набор для катетеризации сосудов новорожденного «Виволанн П» №1286, №С-SP28(В) (серийный, однократного применения) по ТУ 12.50.13.001.34.18.18.22.2019
 19 - 28.10.2022
 20 - 28.10.2022
 21 - 28.10.2022
 22 - 28.10.2022
 23 - 28.10.2022
 24 - 28.10.2022
 25 - 28.10.2022
 26 - 28.10.2022
 27 - 28.10.2022
 28 - 28.10.2022
 29 - 28.10.2022
 30 - 28.10.2022
 31 - 28.10.2022
 32 - 28.10.2022
 33 - 28.10.2022
 34 - 28.10.2022
 35 - 28.10.2022
 36 - 28.10.2022
 37 - 28.10.2022
 38 - 28.10.2022
 39 - 28.10.2022
 40 - 28.10.2022
 41 - 28.10.2022
 42 - 28.10.2022
 43 - 28.10.2022
 44 - 28.10.2022
 45 - 28.10.2022
 46 - 28.10.2022
 47 - 28.10.2022
 48 - 28.10.2022
 49 - 28.10.2022
 50 - 28.10.2022
 51 - 28.10.2022
 52 - 28.10.2022
 53 - 28.10.2022
 54 - 28.10.2022
 55 - 28.10.2022
 56 - 28.10.2022
 57 - 28.10.2022
 58 - 28.10.2022
 59 - 28.10.2022
 60 - 28.10.2022
 61 - 28.10.2022
 62 - 28.10.2022
 63 - 28.10.2022
 64 - 28.10.2022
 65 - 28.10.2022
 66 - 28.10.2022
 67 - 28.10.2022
 68 - 28.10.2022
 69 - 28.10.2022
 70 - 28.10.2022
 71 - 28.10.2022
 72 - 28.10.2022
 73 - 28.10.2022
 74 - 28.10.2022
 75 - 28.10.2022
 76 - 28.10.2022
 77 - 28.10.2022
 78 - 28.10.2022
 79 - 28.10.2022
 80 - 28.10.2022
 81 - 28.10.2022
 82 - 28.10.2022
 83 - 28.10.2022
 84 - 28.10.2022
 85 - 28.10.2022
 86 - 28.10.2022
 87 - 28.10.2022
 88 - 28.10.2022
 89 - 28.10.2022
 90 - 28.10.2022
 91 - 28.10.2022
 92 - 28.10.2022
 93 - 28.10.2022
 94 - 28.10.2022
 95 - 28.10.2022
 96 - 28.10.2022
 97 - 28.10.2022
 98 - 28.10.2022
 99 - 28.10.2022
 100 - 28.10.2022



Виволанн

СТЕРИЛЬНЫЙ, ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- Запрещается повторное введение, частично или полностью выходящее из периферического веноус/дистального катетера.
- Катетерический запорщик использовать категорически через иглу и периферический катетер.
- Катетерический запорщик использовать шприцы объемом менее 10 мл.
- После использования набор расмачивается охлаждать в течение 15 мин. при температуре от 0 до +5°C.

НЕТОКСИЧНО РЕГЕНЕРОСПОСОБНЫЙ



Набор для катетеризации сосудов новорожденного «Виволанн П» №1286, №С-SP28(В) (серийный, однократного применения) в составе:

- Катетер венозный, центральный, однократный, радиостимуляционный, полимерный, с изогнутой длиной 0,30 м (1 Ft), с эффективной длиной 28 см - 1 шт.
- Игла расщепленная для введения катетера 0,7 x 19 мм (24 G) - 1 шт.
- Запорщик - 1 шт.
- Защитная вставка с-шланг - 1 шт.
- Лента капроновая - 1 шт.
- Инструкция по применению - 1 шт.

25.10.2019 28.10.2022
 №1286 №С-SP28(В) ТУ 12.50.13.001.34.18.18.22.2019
 19-28.10.2022
 20-28.10.2022
 21-28.10.2022
 22-28.10.2022
 23-28.10.2022
 24-28.10.2022
 25-28.10.2022
 26-28.10.2022
 27-28.10.2022
 28-28.10.2022
 29-28.10.2022
 30-28.10.2022
 31-28.10.2022
 32-28.10.2022
 33-28.10.2022
 34-28.10.2022
 35-28.10.2022
 36-28.10.2022
 37-28.10.2022
 38-28.10.2022
 39-28.10.2022
 40-28.10.2022
 41-28.10.2022
 42-28.10.2022
 43-28.10.2022
 44-28.10.2022
 45-28.10.2022
 46-28.10.2022
 47-28.10.2022
 48-28.10.2022
 49-28.10.2022
 50-28.10.2022
 51-28.10.2022
 52-28.10.2022
 53-28.10.2022
 54-28.10.2022
 55-28.10.2022
 56-28.10.2022
 57-28.10.2022
 58-28.10.2022
 59-28.10.2022
 60-28.10.2022
 61-28.10.2022
 62-28.10.2022
 63-28.10.2022
 64-28.10.2022
 65-28.10.2022
 66-28.10.2022
 67-28.10.2022
 68-28.10.2022
 69-28.10.2022
 70-28.10.2022
 71-28.10.2022
 72-28.10.2022
 73-28.10.2022
 74-28.10.2022
 75-28.10.2022
 76-28.10.2022
 77-28.10.2022
 78-28.10.2022
 79-28.10.2022
 80-28.10.2022
 81-28.10.2022
 82-28.10.2022
 83-28.10.2022
 84-28.10.2022
 85-28.10.2022
 86-28.10.2022
 87-28.10.2022
 88-28.10.2022
 89-28.10.2022
 90-28.10.2022
 91-28.10.2022
 92-28.10.2022
 93-28.10.2022
 94-28.10.2022
 95-28.10.2022
 96-28.10.2022
 97-28.10.2022
 98-28.10.2022
 99-28.10.2022
 100-28.10.2022

Набор для катетеризации сосудов новорожденного «Виволанн П» №246, №С-SP30(О) (серийный, однократного применения) по ТУ 12.50.13.001.34.18.18.22.2019
 19 - 28.10.2022
 20 - 28.10.2022
 21 - 28.10.2022
 22 - 28.10.2022
 23 - 28.10.2022
 24 - 28.10.2022
 25 - 28.10.2022
 26 - 28.10.2022
 27 - 28.10.2022
 28 - 28.10.2022
 29 - 28.10.2022
 30 - 28.10.2022
 31 - 28.10.2022
 32 - 28.10.2022
 33 - 28.10.2022
 34 - 28.10.2022
 35 - 28.10.2022
 36 - 28.10.2022
 37 - 28.10.2022
 38 - 28.10.2022
 39 - 28.10.2022
 40 - 28.10.2022
 41 - 28.10.2022
 42 - 28.10.2022
 43 - 28.10.2022
 44 - 28.10.2022
 45 - 28.10.2022
 46 - 28.10.2022
 47 - 28.10.2022
 48 - 28.10.2022
 49 - 28.10.2022
 50 - 28.10.2022
 51 - 28.10.2022
 52 - 28.10.2022
 53 - 28.10.2022
 54 - 28.10.2022
 55 - 28.10.2022
 56 - 28.10.2022
 57 - 28.10.2022
 58 - 28.10.2022
 59 - 28.10.2022
 60 - 28.10.2022
 61 - 28.10.2022
 62 - 28.10.2022
 63 - 28.10.2022
 64 - 28.10.2022
 65 - 28.10.2022
 66 - 28.10.2022
 67 - 28.10.2022
 68 - 28.10.2022
 69 - 28.10.2022
 70 - 28.10.2022
 71 - 28.10.2022
 72 - 28.10.2022
 73 - 28.10.2022
 74 - 28.10.2022
 75 - 28.10.2022
 76 - 28.10.2022
 77 - 28.10.2022
 78 - 28.10.2022
 79 - 28.10.2022
 80 - 28.10.2022
 81 - 28.10.2022
 82 - 28.10.2022
 83 - 28.10.2022
 84 - 28.10.2022
 85 - 28.10.2022
 86 - 28.10.2022
 87 - 28.10.2022
 88 - 28.10.2022
 89 - 28.10.2022
 90 - 28.10.2022
 91 - 28.10.2022
 92 - 28.10.2022
 93 - 28.10.2022
 94 - 28.10.2022
 95 - 28.10.2022
 96 - 28.10.2022
 97 - 28.10.2022
 98 - 28.10.2022
 99 - 28.10.2022
 100 - 28.10.2022



Виволанн

СТЕРИЛЬНЫЙ, ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- Запрещается повторное введение, частично или полностью выходящее из периферического веноус/дистального катетера.
- Катетерический запорщик использовать категорически через иглу и периферический катетер.
- Катетерический запорщик использовать шприцы объемом менее 10 мл.
- После использования набор расмачивается охлаждать в течение 15 мин. при температуре от 0 до +5°C.

НЕТОКСИЧНО РЕГЕНЕРОСПОСОБНЫЙ



Набор для катетеризации сосудов новорожденного «Виволанн П» №246, №С-SP30(О) (серийный, однократного применения) в составе:

- Катетер венозный, центральный, однократный, радиостимуляционный, полимерный, с изогнутой длиной 0,60 м (2 Ft), с эффективной длиной 30 см - 1 шт.
- Игла расщепленная для введения катетера 1,1 x 25 мм (22 G) - 1 шт.
- Запорщик - 2 шт.
- Защитная вставка с-шланг - 2 шт.
- Лента капроновая - 1 шт.
- Инструкция по применению - 1 шт.

25.10.2019 28.10.2022
 №246 №С-SP30(О) ТУ 12.50.13.001.34.18.18.22.2019
 19-28.10.2022
 20-28.10.2022
 21-28.10.2022
 22-28.10.2022
 23-28.10.2022
 24-28.10.2022
 25-28.10.2022
 26-28.10.2022
 27-28.10.2022
 28-28.10.2022
 29-28.10.2022
 30-28.10.2022
 31-28.10.2022
 32-28.10.2022
 33-28.10.2022
 34-28.10.2022
 35-28.10.2022
 36-28.10.2022
 37-28.10.2022
 38-28.10.2022
 39-28.10.2022
 40-28.10.2022
 41-28.10.2022
 42-28.10.2022
 43-28.10.2022
 44-28.10.2022
 45-28.10.2022
 46-28.10.2022
 47-28.10.2022
 48-28.10.2022
 49-28.10.2022
 50-28.10.2022
 51-28.10.2022
 52-28.10.2022
 53-28.10.2022
 54-28.10.2022
 55-28.10.2022
 56-28.10.2022
 57-28.10.2022
 58-28.10.2022
 59-28.10.2022
 60-28.10.2022
 61-28.10.2022
 62-28.10.2022
 63-28.10.2022
 64-28.10.2022
 65-28.10.2022
 66-28.10.2022
 67-28.10.2022
 68-28.10.2022
 69-28.10.2022
 70-28.10.2022
 71-28.10.2022
 72-28.10.2022
 73-28.10.2022
 74-28.10.2022
 75-28.10.2022
 76-28.10.2022
 77-28.10.2022
 78-28.10.2022
 79-28.10.2022
 80-28.10.2022
 81-28.10.2022
 82-28.10.2022
 83-28.10.2022
 84-28.10.2022
 85-28.10.2022
 86-28.10.2022
 87-28.10.2022
 88-28.10.2022
 89-28.10.2022
 90-28.10.2022
 91-28.10.2022
 92-28.10.2022
 93-28.10.2022
 94-28.10.2022
 95-28.10.2022
 96-28.10.2022
 97-28.10.2022
 98-28.10.2022
 99-28.10.2022
 100-28.10.2022

[illegible]

СИТУАЦИОННИ, ОПЕРОПАТНОР О ПРИБЛИЖИТЕЛНО

MONOCYTE

- Запрещается повторное вращение участка или полностью вытеснить и/или парфюмерного аэрозоль/диффузор калегрей.
- Категорически запрещается изменять катетр повторно через и/или парфюмерного калегрей.
- Катетр должен быть закреплён надёжно, ширина обхвата не менее 10 мм.
- После использования набор рекомендуется хранить в течение 15 мин. при температуре от 0 до +5°C.

[illegible]

METOKLOPRAMID PENTTENOHEIPROZPACHNIM

Набор для катетеризации ссуд/а/е новорожденного
«Виволанн С» 2F/24G, NС-SS30E(СI)


«Виволтайн С» 2F/24G, NC-SS30E(CI)

- [illegible]


101 44251019

PHY 101-00000

000 000 0




1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656 2657 2658 2659 2660 2661 2662 2663 2664 2665 2666 2667 2668 2669 2670 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678 2679 2680 2681 2682 2683 2684 2685 2686 2687 2688 2689 2690 2691 2692 2693 2694 2695 2696 2697 2698 2699 2700 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2709 2710 2711 2712 2713 2714 2715 2716 2717 2718 2719 2720 2721 2722 2723 2724 2725 2726 2727 2728 2729 2730 2731 2732 2733 2734 2735 2736 2737 2738 2739 2740 2741 2742 2743 2744 2745 2746 2747 2748 2749 2750 2751 2752 2753 2754 2755 2756 2757 2758 2759 2760 2761 2762 2763 2764 2765 2766 2767 2768 2769 2770 2771 2772 2773 2774 2775 2776 2777 2778 2779 2780 2781 2782 2783 2784 2785 2786 2787 2788 2789 2790 2791 2792 2793 2794 2795 2796 2797 2798 2799 2800 2801 2802 2803 2804 2805 2806 2807 2

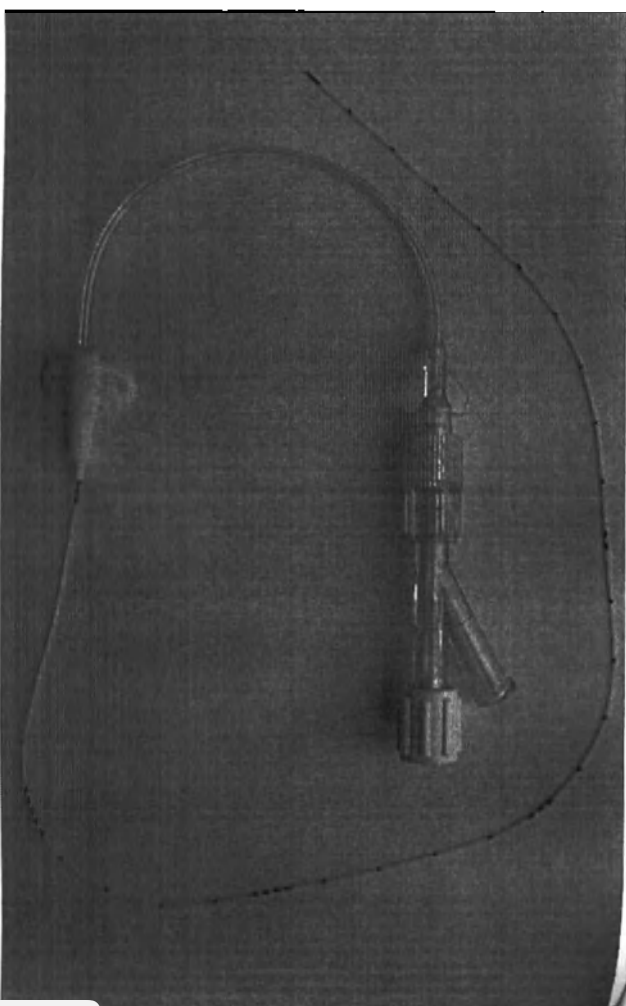


категор жемчужина цыганщины, олимпийский, рентгенограф, театр, пазар, германский, с наукой, планшет 0,30 мм (17), с эффективной длиной 28 см, со ступенем – общий вид в обзоре с заданной винтовой, с кривой


Катетер венозный центральный, однокамерный, перитентнокатетерный, полиуретановый,
с наружной длиной 0,30 м (1 FT), с эффективной длиной 28 см, со стилетом – ватный Y-образный конектор

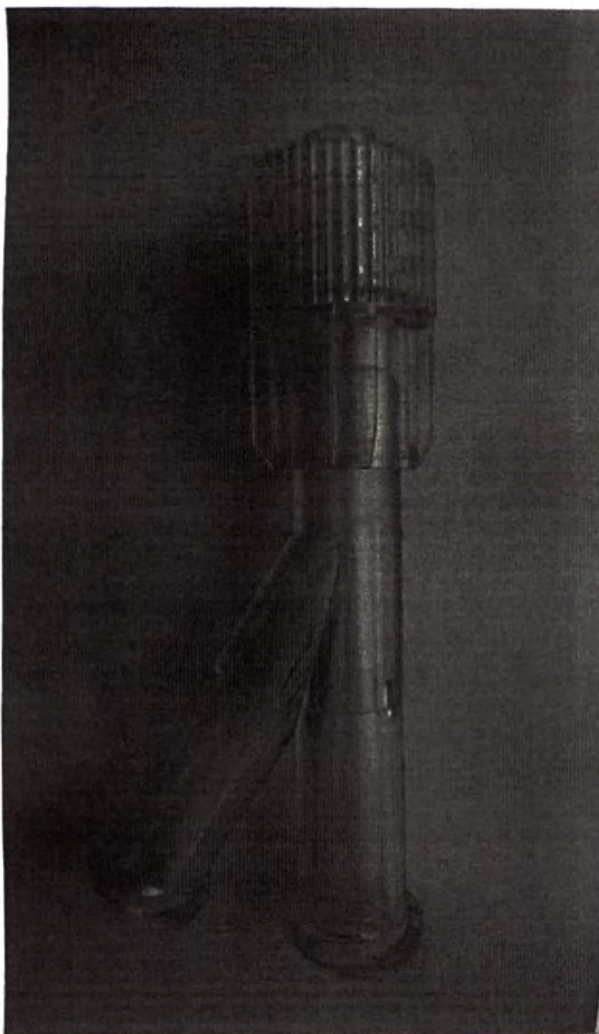


Катетер венозный центральный, однокамерный, перитентнокатетерный, полиуретановый,
с наружной длиной 0,30 м (1 FT), с эффективной длиной 28 см, со стилетом – канюля катетра и флуидит удлинителя прилеп

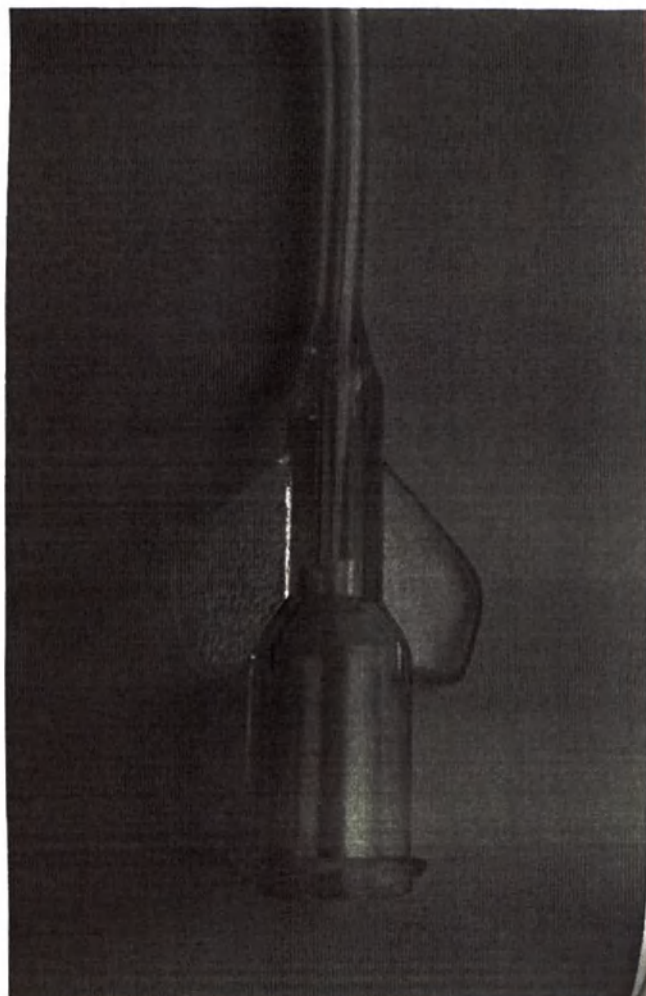


Катетр венозный периферный, описанный, рентгеноконтрастный, полиуретановый,
с наружной длиной 0,30 м (1 фут), с эффективной длиной 28 см, со структурой - осциллирующий утка

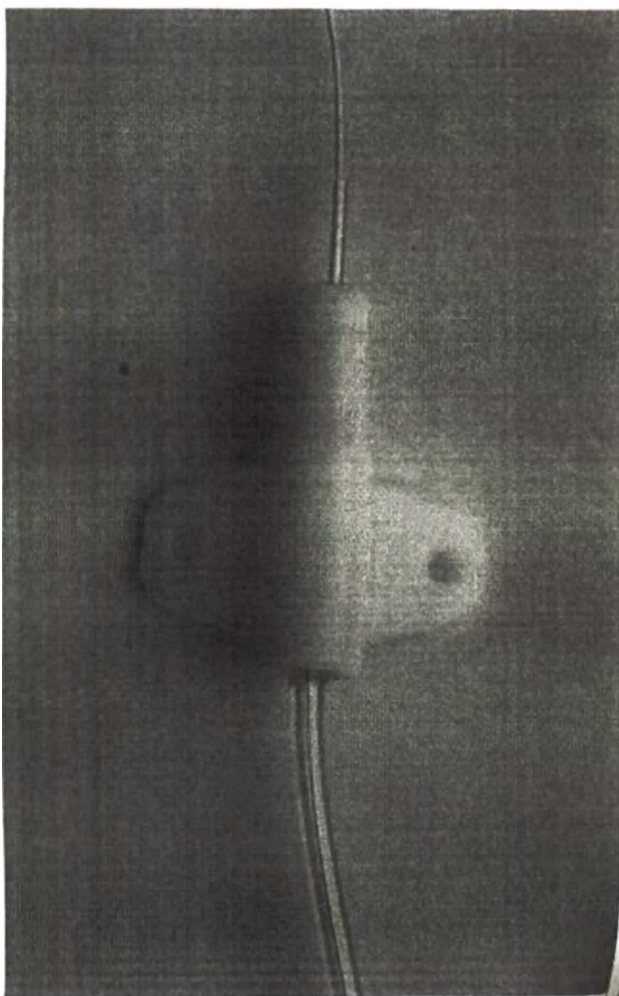

Катетер венозный периферный, описанный, рентгеноконтрастный, полиуретановый,
с наружной длиной 0,30 м (1 фут), с эффективной длиной 28 см, со структурой - гладкий, для лаковой шпиги катетера с шпигином

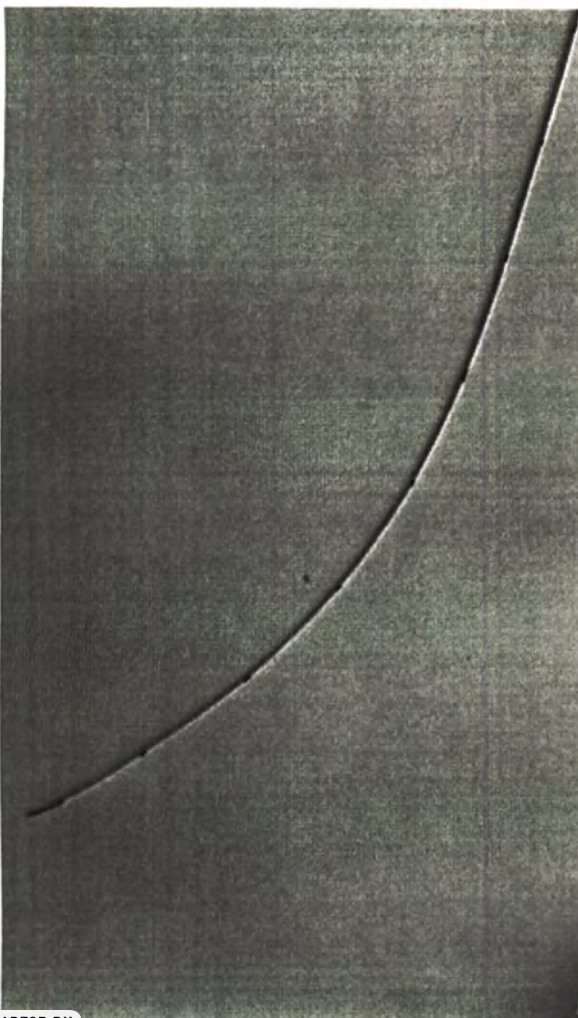


Картер всасной установки, оловянистой, поршневого типа, поперечный
с наружным диаметром 0,50 мм (1 Ft) с эффективным диаметром 28 см, со стрелой - стрел

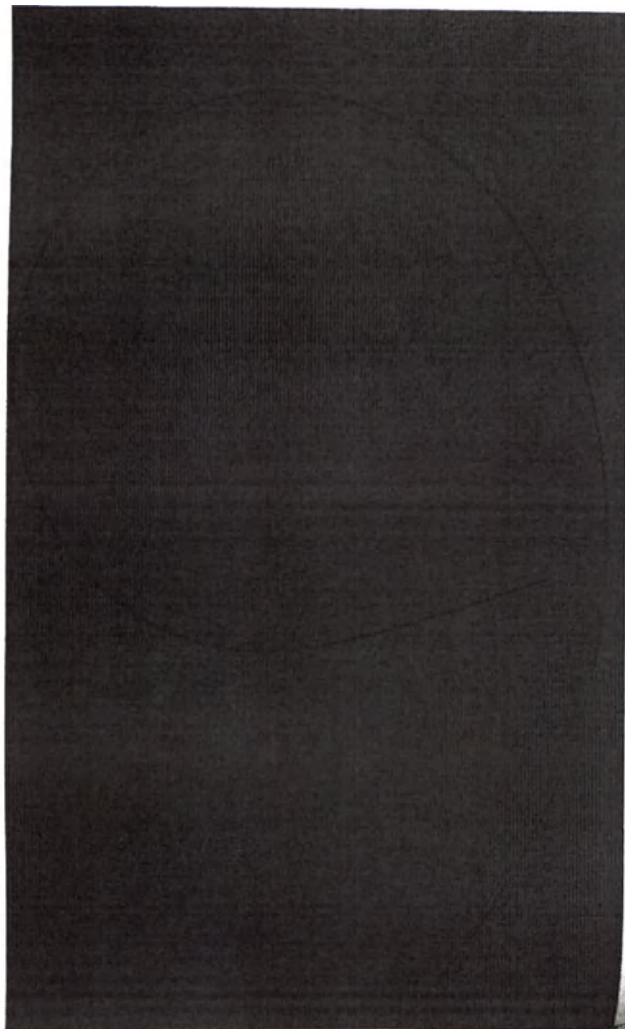


Зеленый картер всасной установки



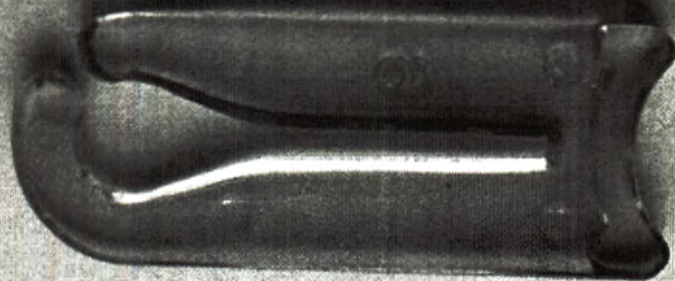


Джонс

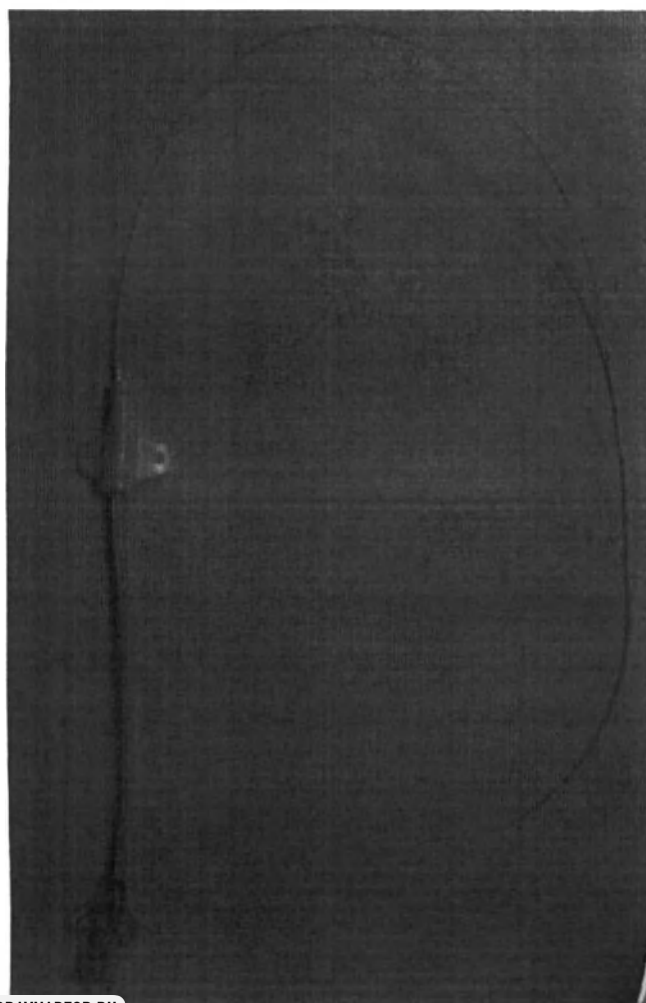


Классический вариант оформления входной двери. Дверь выполнена из массива дерева, имеет классический дизайн. Дверь установлена на пороге.


Катерг жезолнай истрпалнай, аномалалнай, реттискокорперидай, пазурпеталондай, с нагужалал диаметр 0,60 мм (2 F), с аффертиной кинелай 28 мм, с
структур – обшай миз

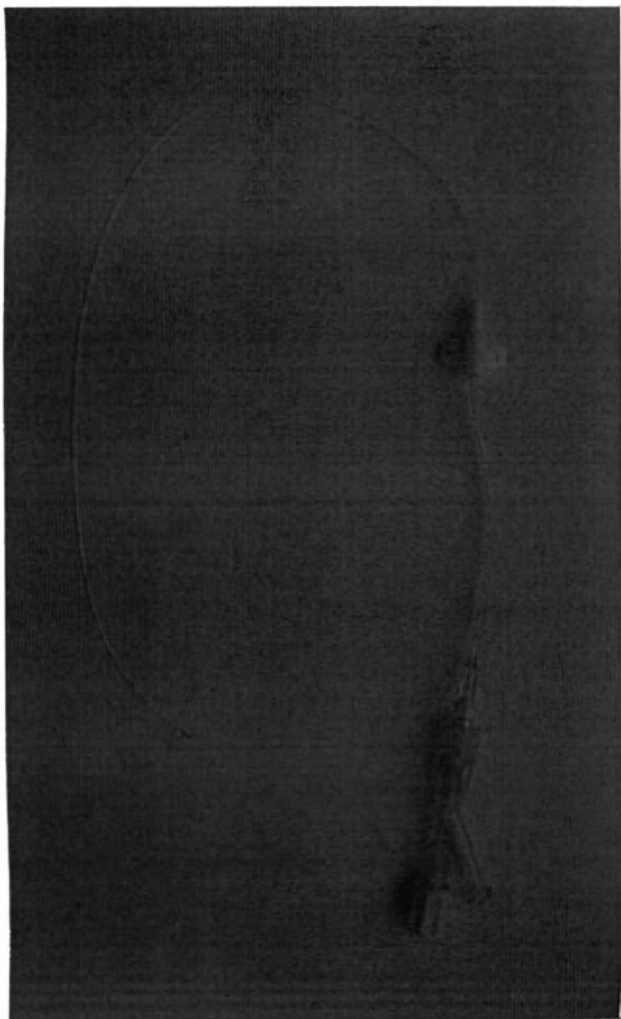


Катерг жезолнай истрпалнай, аномалалнай, реттискокорперидай, пазурпеталондай, с нагужалал диаметр 0,60 мм (2 F), с аффертиной кинелай 28 мм, с
структур – обшай миз

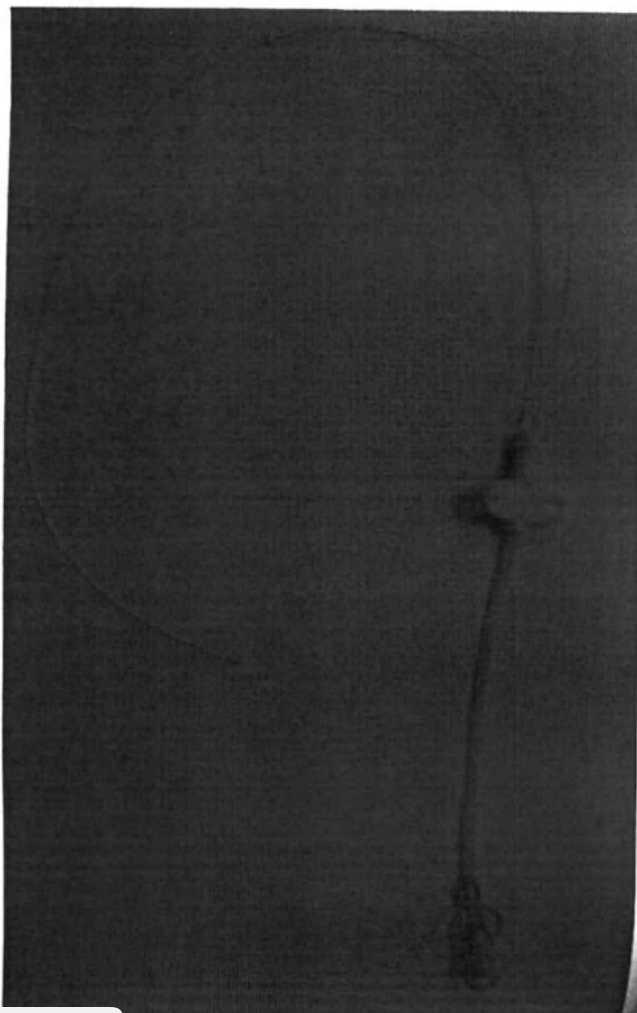

Катетер менингеальный, асептический, рентгеноконтрастный, полиуретановый, с наружным диаметром 0,90 мм и 2 FRL, с эффективной длиной 30 см, общий вид

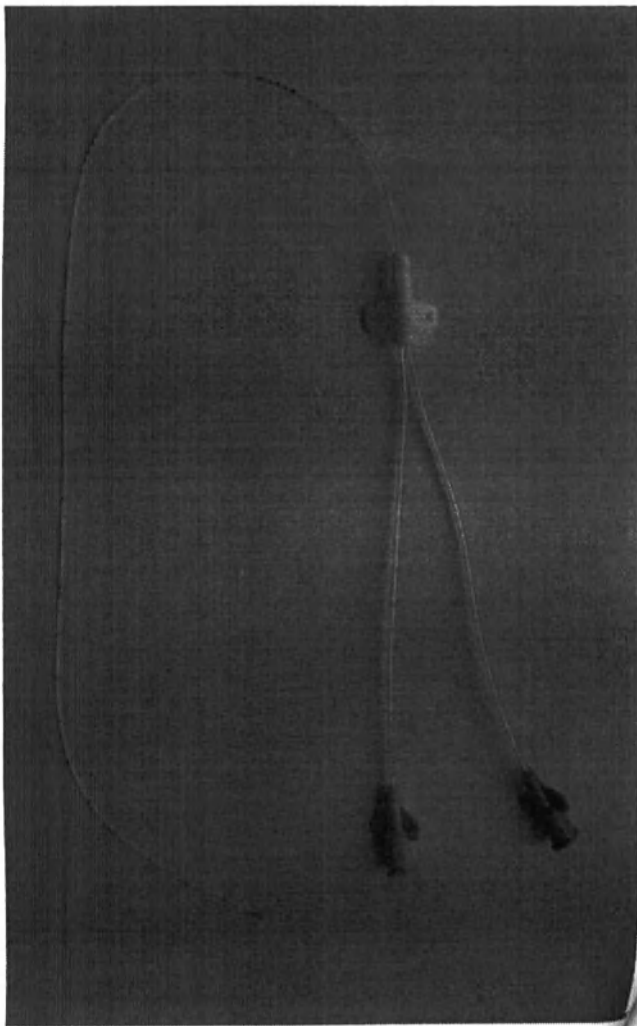


Катетер менингеальный, асептический, рентгеноконтрастный, асептический, с наружным диаметром 0,90 мм и 2 FRL, с эффективной длиной 30 см, вид

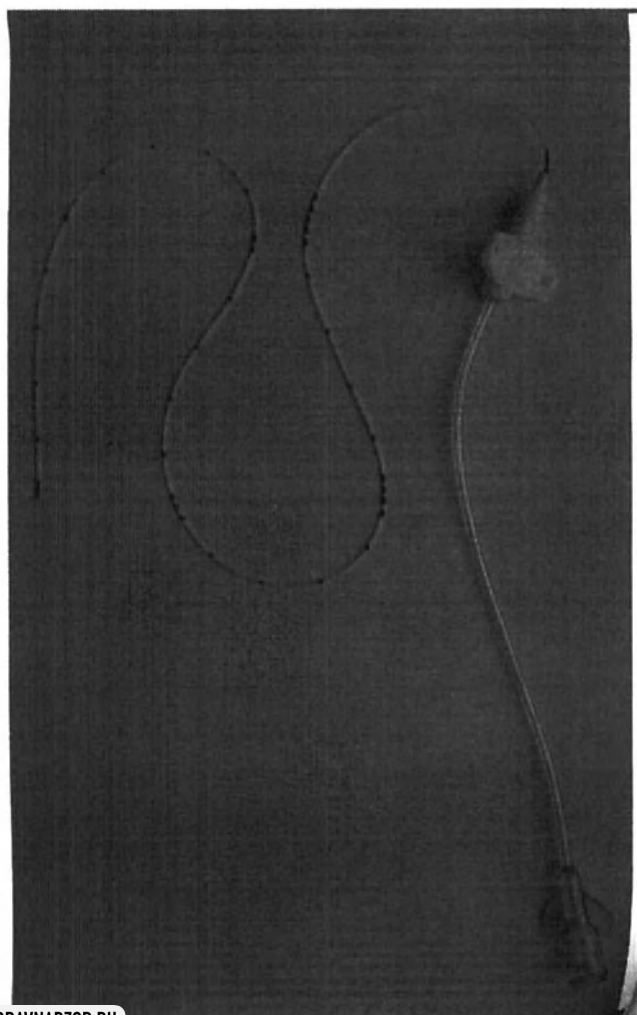

A dark, textured surface, possibly a book cover or endpaper, featuring a faint, large, stylized outline of a human figure or a similar shape. The figure is composed of a curved line forming the torso and limbs, with a small, dark, rectangular object attached to the right side, resembling a pocket or a small bag. The overall appearance is aged and worn.

Катетр по трем сторонам периферической ретины (1, 1' - 25 мм (2,25°) - общий вид в сборе

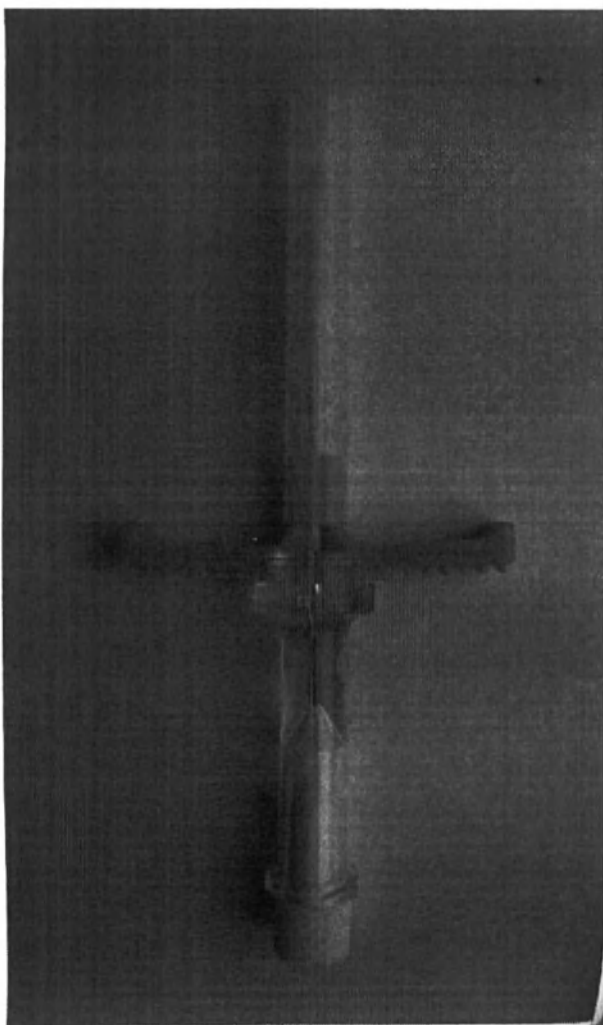

Катетр по трем сторонам периферической ретины (1, 1' - 25 мм (2,25°) - общий вид, 1 - проекционный контур, 2 - элемент катетра, 3 - вид в сборе

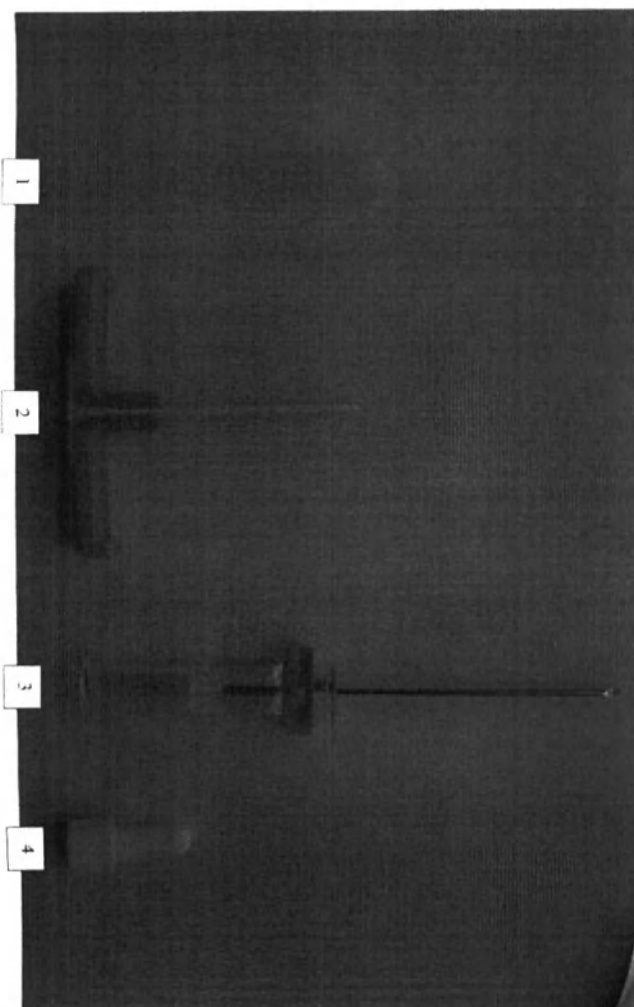


Иллюстрация для раздела каталога 1,1 x 19 мм
1. Иллюстрация для раздела каталога 1,1 x 19 мм, 2. иллюстрация для раздела каталога



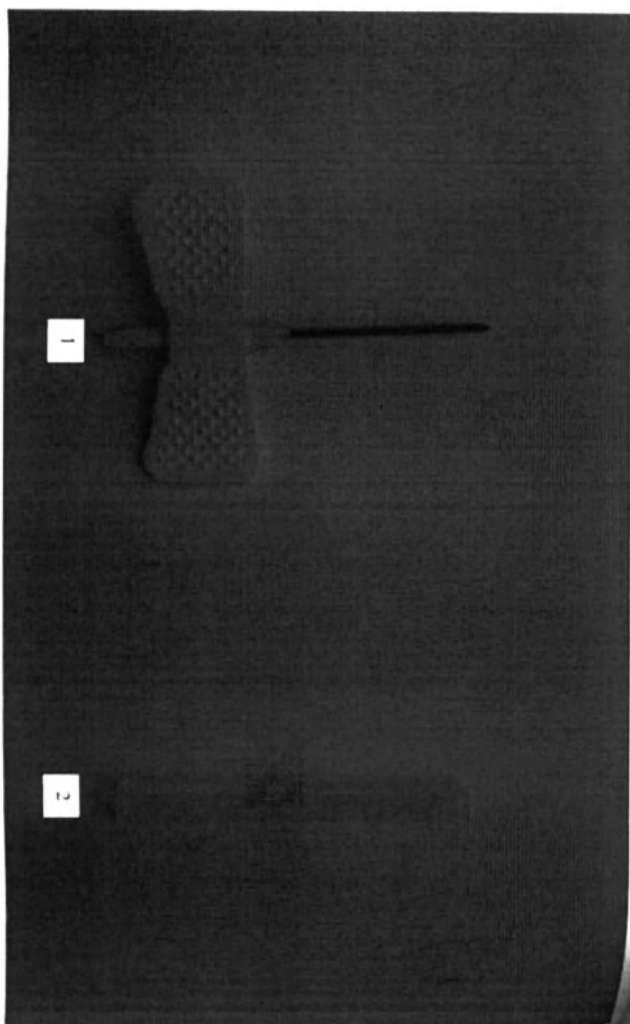



Иллюстрация для раздела каталога 0,7 x 19 мм (24 Г) - общий вид

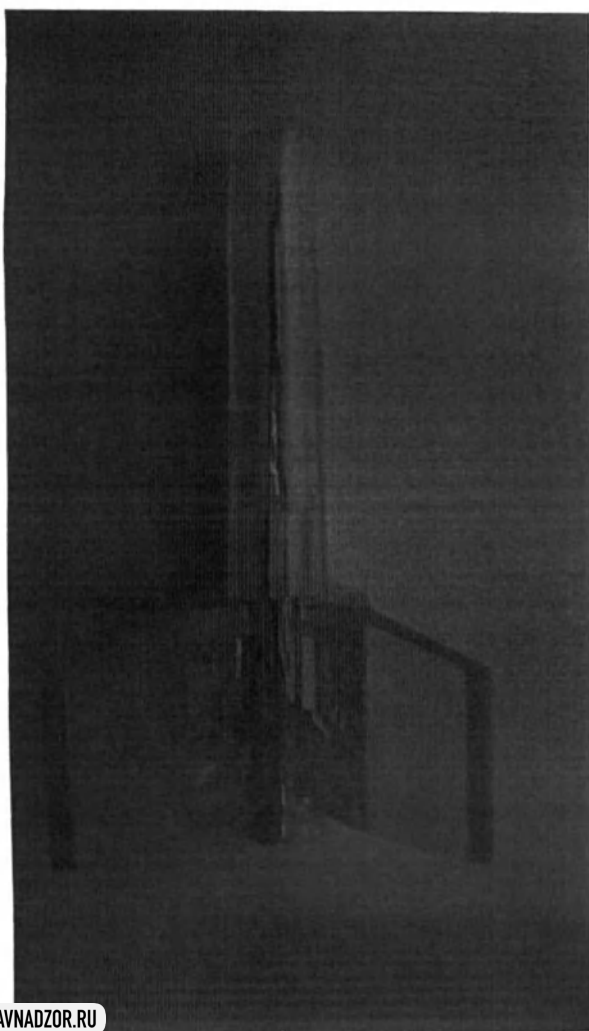


Катерг мутпрессу джстай перфдерпресский нолупетаный 0,7 · 19 мм (24 G) – олшый мэл в олпре

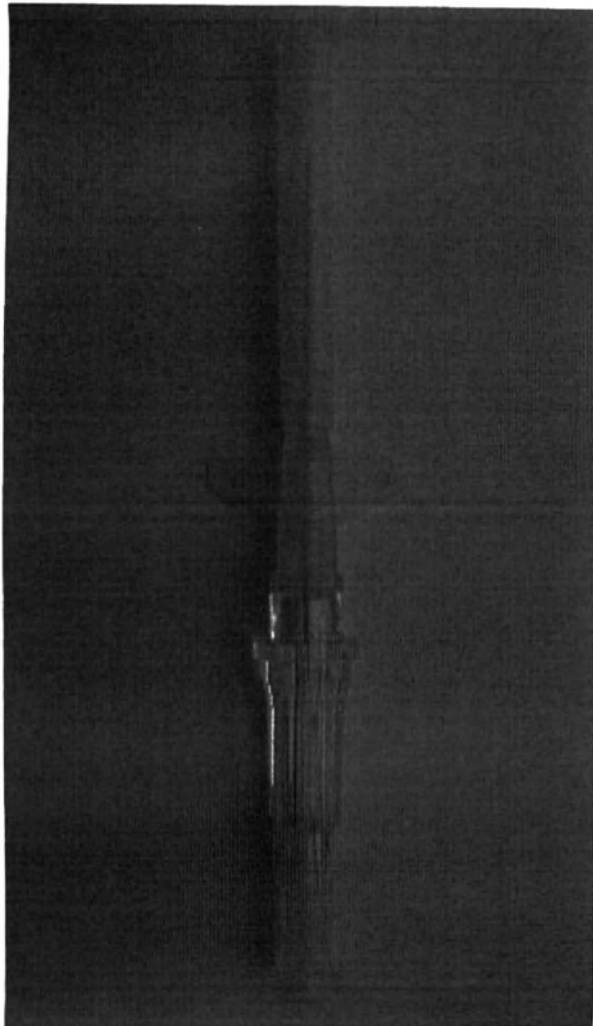

Катерг мутпрессу джстай перфдерпресский нолупетаный 0,7 · 19 мм (24 G):
1 – прелдерпрелтлелый коллеллел; 2 – нелелел калелрел; 3 – нелел; 4 – прелелелелелелел

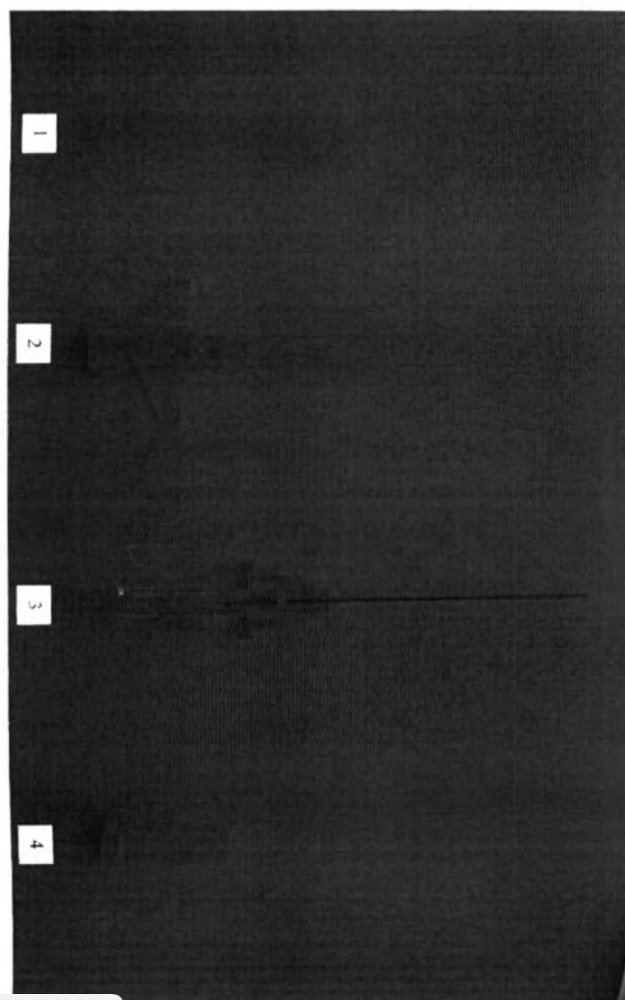

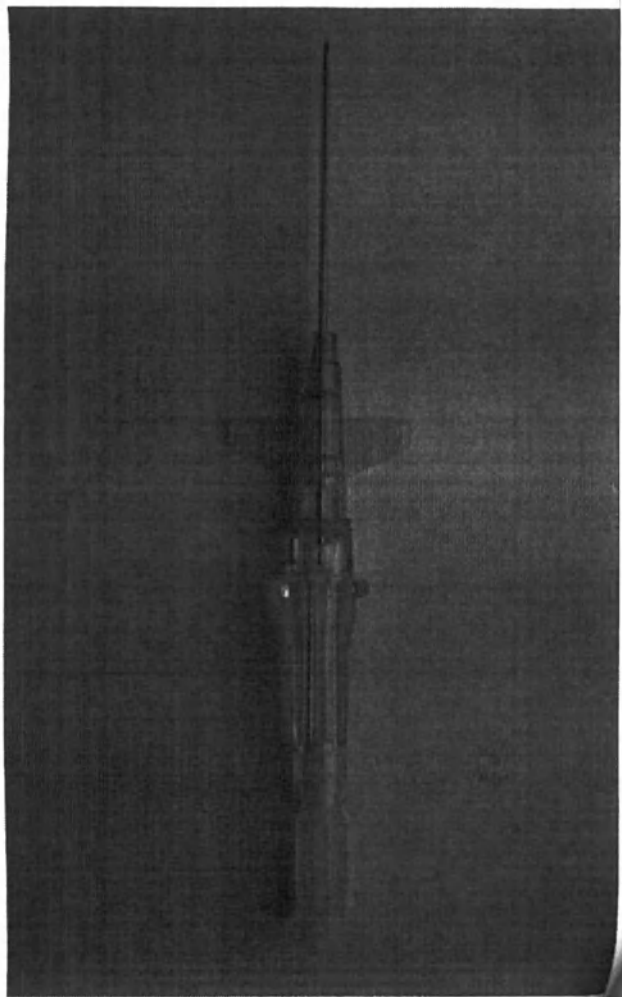


Катетер для прокола дилататора периферического (Л - 70 см, 20 кД) диаметр иглы в центре (определяется) и диаметр катетера




Катетер для прокола дилататора периферического (ПФ-0.6 - 19 см (26 Г) - 4 кД) и игла

Катетр внутрисосудистый периферический ППФ 0,7 × 19 мм (24 G) – общий вид

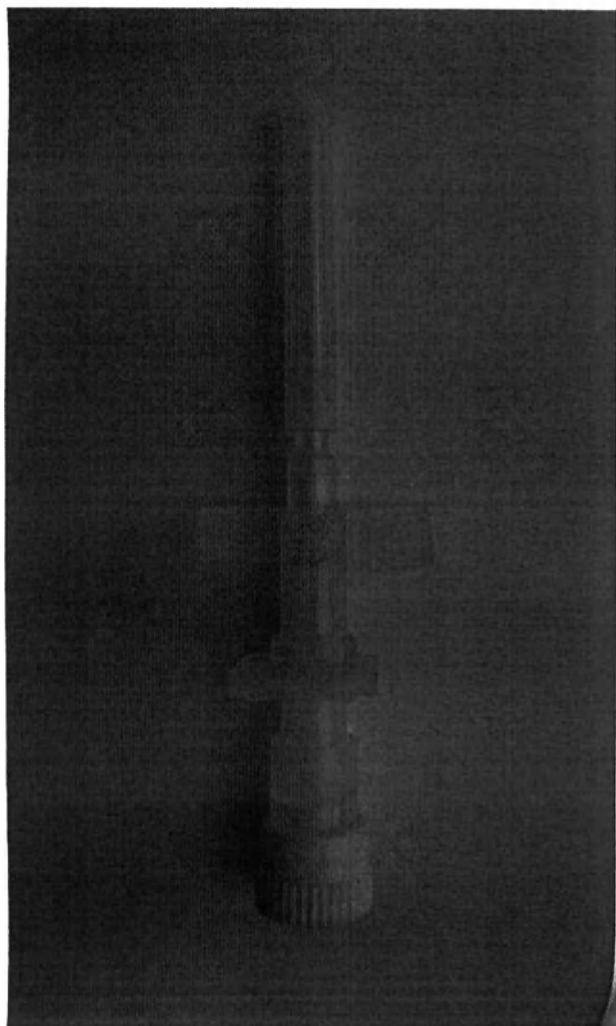

Катетр внутрисосудистый периферический ППФ 0,7 × 19 мм (24 G)
1 – предохранительный кожухок; 2 – датчик катетера; 3 – нитка; 4 – проба катетера

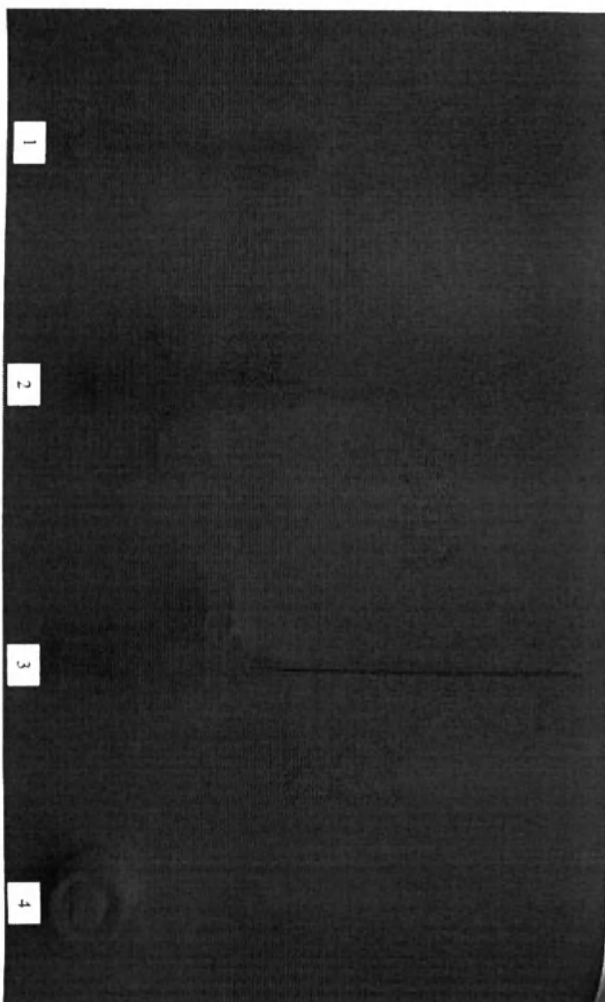

Pharmaceutical innovation


ОБОБЩАЮЩИЕ ПОДЗЕМНИ

46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

На правах
авторского
заказа
Издательство
«Искусство»
Москва, 1989
32 с. 13 001.
34161872-2019-
Удостоверен
магистерской



бор для катетеризации сосудов новорожденного «Виволайн ПС» 1F/28G, NC-SP28S(B) стерильный,
однократного применения по ТУ 32.50.13-001-34161832-2019 – пример групповой упаковки с
маркировкой

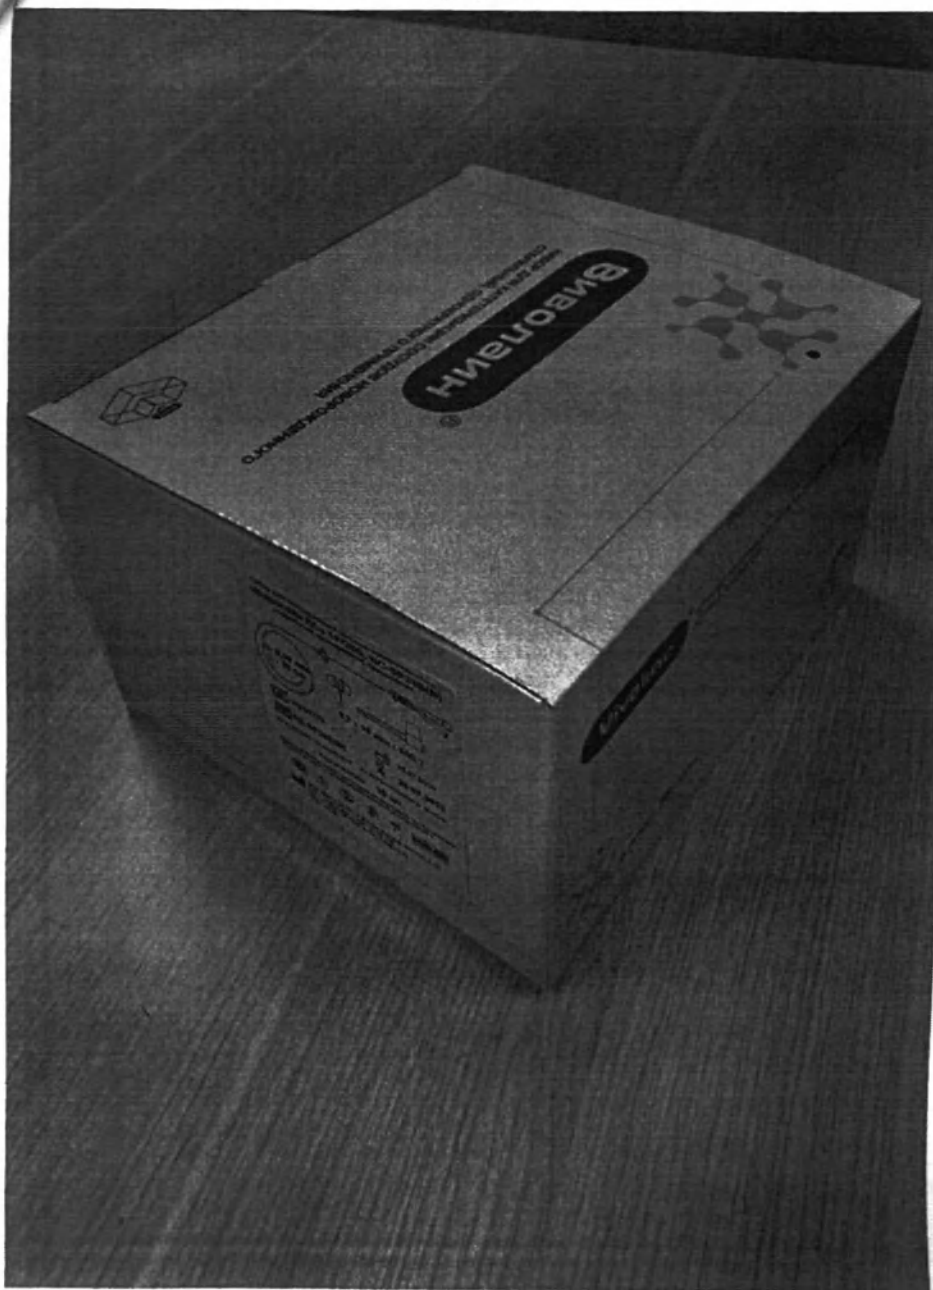

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью: 57 14424900000000000000 лист(а/ов)
Генеральный директор ООО «ВМТ»



Д.И. Рымбаковский