


Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
«Набор реагентов для иммуноферментного выявления HBs-антигена вируса гепатита В (HBsAg-ИФА-БЕСТ) по ТУ 9398-332-23548172-2012» (комплект 1/авто)

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест» Хусаинов М.Д.
103 2022 г.

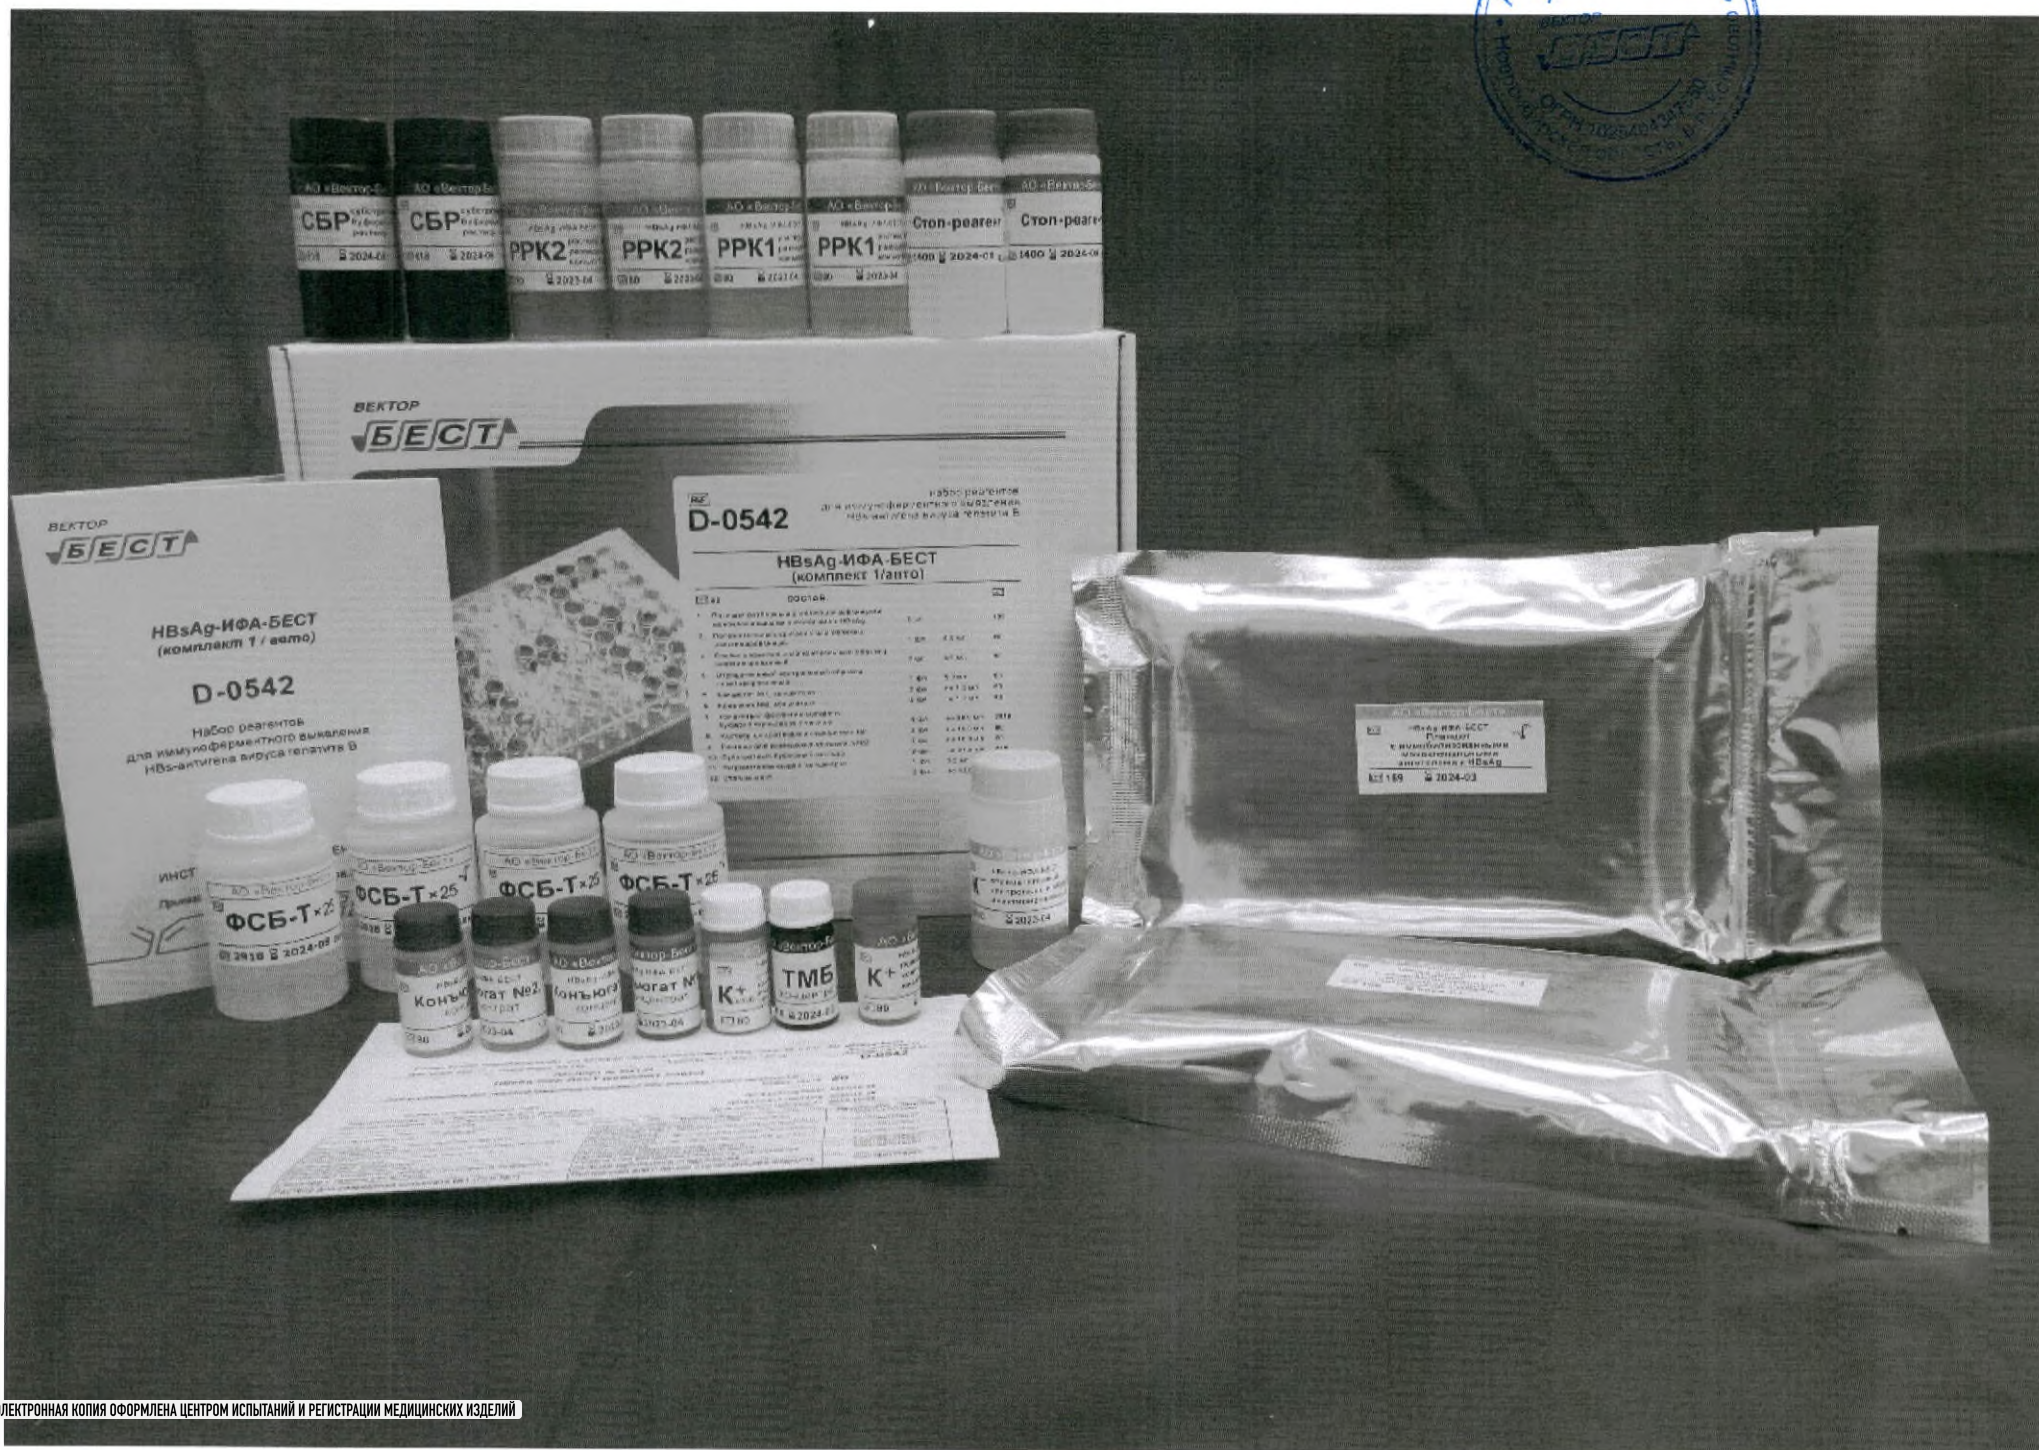

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия

«Набор реагентов для иммуноферментного выявления HBs-антигена вируса гепатита В (HBsAg-ИФА-БЕСТ) по ТУ 9398-332-23548172-2012» (комплект 1/авто) №1

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»


Хусаинов М.Д.

2022 г.



ВЕКТОР

БЕСТ

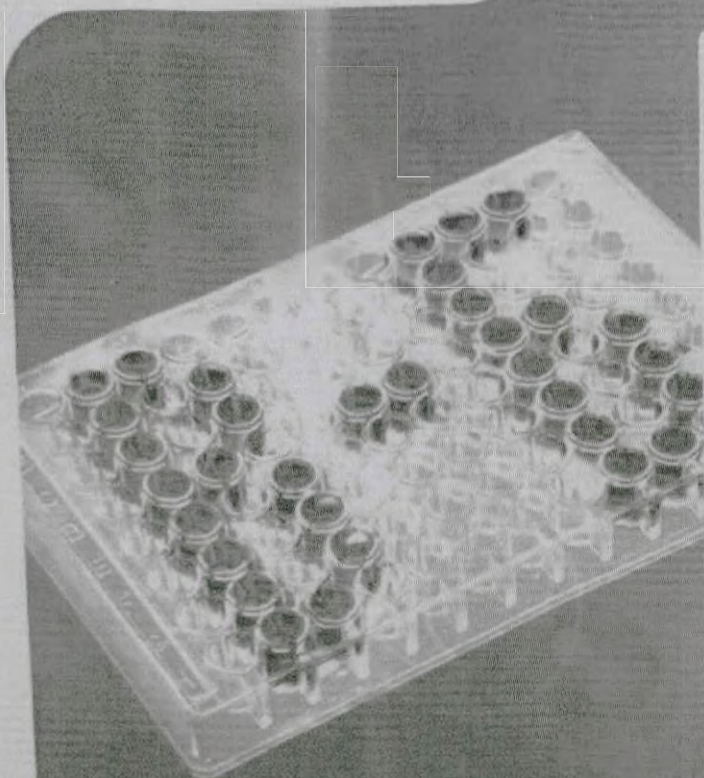

REF

D-0542

набор реагентов
для иммуноферментного выявления
HBs-антигена вируса гепатита В

HBsAg-ИФА-БЕСТ (комплект 1/авто)

80

СОСТАВ:

80

1. Планшет разборный с иммобилизованными моноклональными антителами к HBsAg	2 шт.		189
2. Положительный контрольный образец, инактивированный	1 фл.	4,0 мл	80
3. Слаболожительный контрольный образец, инактивированный	1 фл.	4,0 мл	80
4. Отрицательный контрольный образец, инактивированный	1 фл.	5,0 мл	80
5. Конъюгат №1, концентрат	2 фл.	по 1,2 мл	80
6. Конъюгат №2, концентрат	2 фл.	по 1,7 мл	80
7. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твинном	4 фл.	по 28,0 мл	2918
8. Раствор для разведения конъюгата №1	2 фл.	по 10,0 мл	80
9. Раствор для разведения конъюгата №2	2 фл.	по 16,0 мл	80
10. Субстратный буферный раствор	2 фл.	по 21,0 мл	618
11. Тетраметилбензидин, концентрат	1 фл.	3,5 мл	40616
12. Стоп-реагент	2 фл.	по 12,0 мл	1400

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия

«Набор реагентов для иммуноферментного выявления HBs-антигена вируса гепатита В (HBsAg-ИФА-БЕСТ) по ТУ 9398-332-23548172-2012» (комплект 1/авто) №2

Генеральный директор

АО «Вектор-Бест»


Хусаинов М.Д.

2022 г.



BEKTOP

БЕСТ

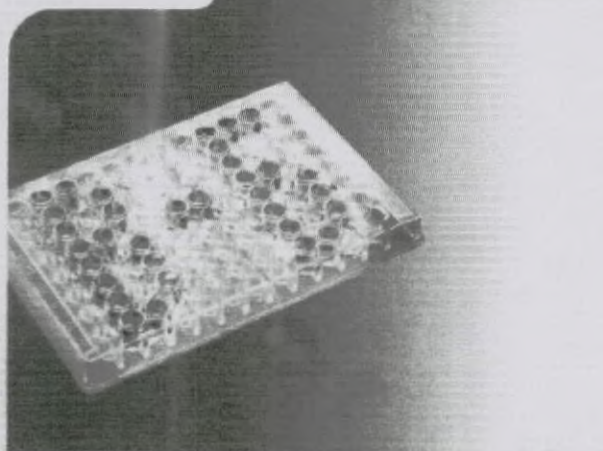

REF **D-0542**

Σ 24x8

LOT

80

ТУ 9398-332-23548172-2012

РУ № ФСР 2012/13925 от 25.03.2017



2021-10-29



2022-10-29

HBsAg-ИФА-БЕСТ (комплект 1/авто)

IVD



05422910220008000891

Антитела к ВИЧ-1,2 и вирусу гепатита С отсутствуют


Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия

«Набор реагентов для иммуноферментного выявления HBs-антигена вируса гепатита В (HBsAg-ИФА-ИЛС 1) по ТУ 9398-332-23548172-2012» (комплект 1/авто) №1

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

Хусаинов М.Д.

2022 г.

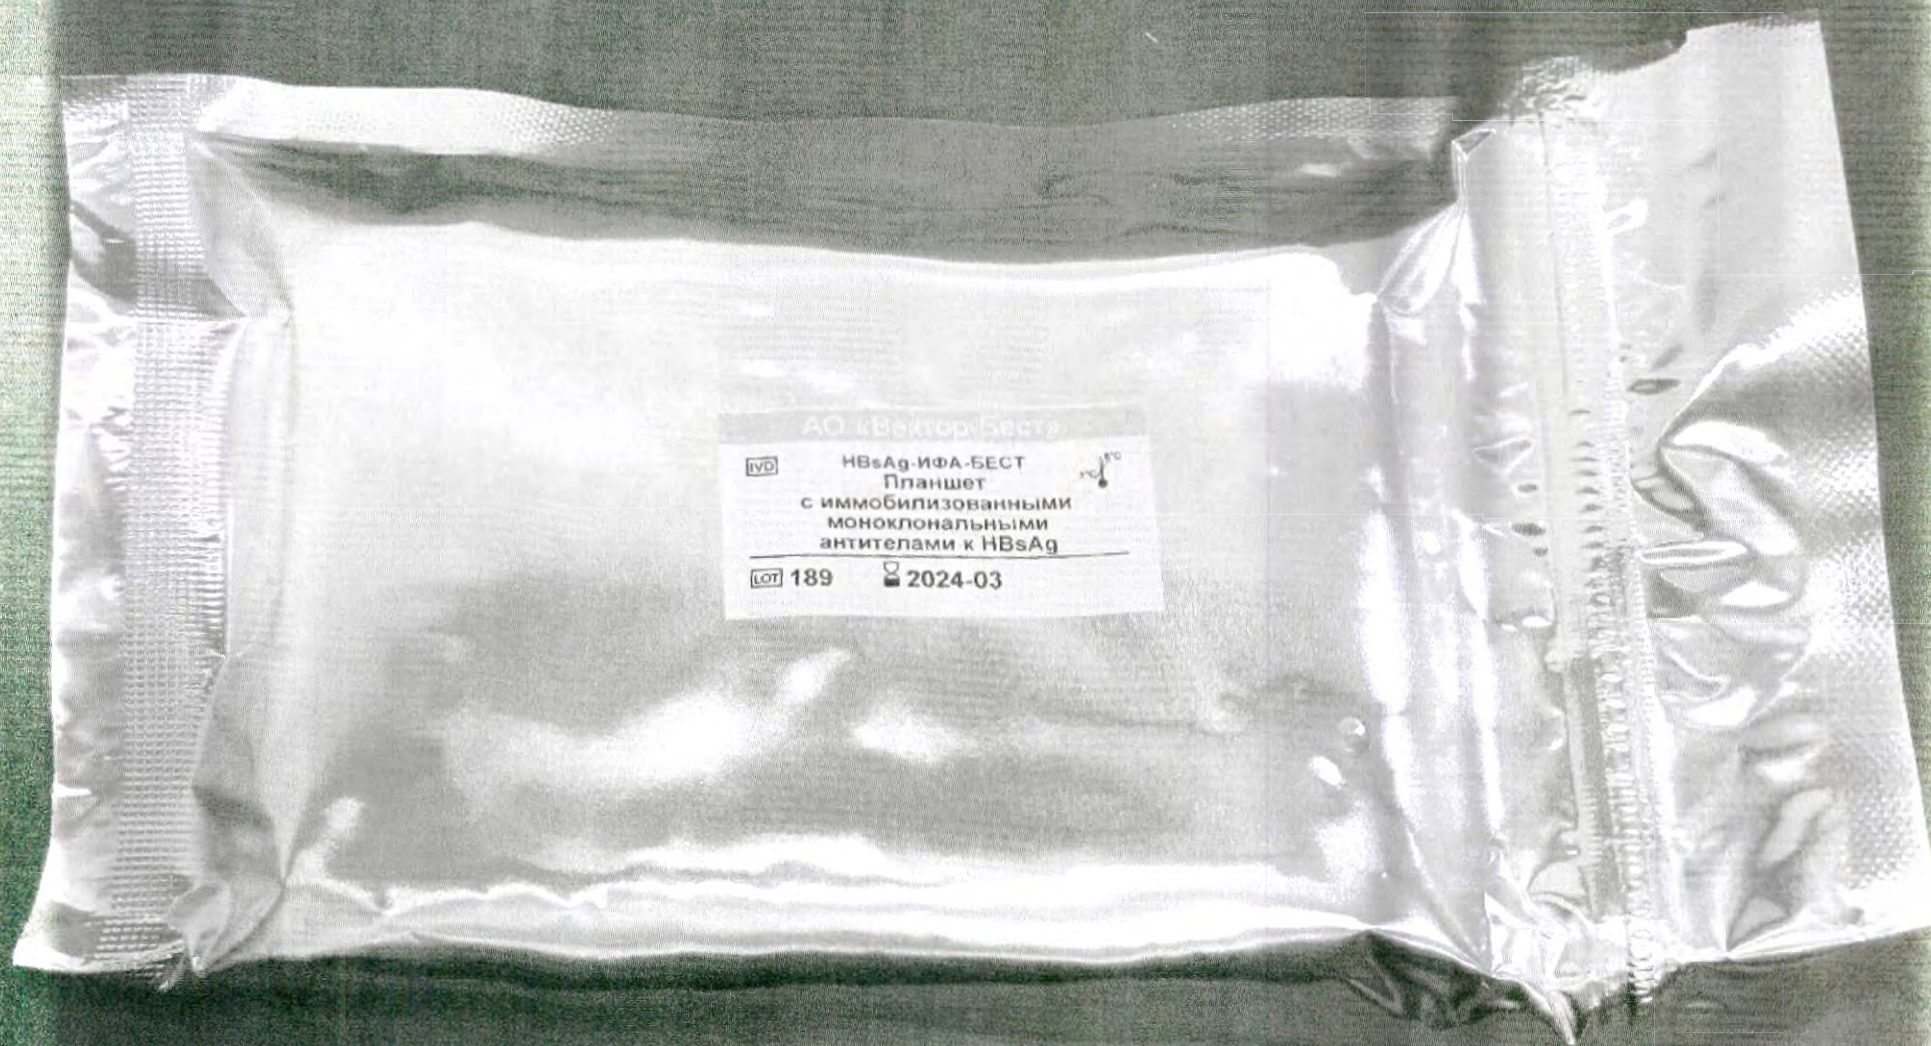

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия

«Набор реагентов для иммуноферментного выявления HBs-антигена вируса гепатита В (HBsAg-ИФА-БЕСТ) по ТУ 9398-332-23548172-2012» (комплект 1/авто) №2

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

Хусаинов М.Д.

2022 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия

«Набор реагентов для иммуноферментного выявления HBs-антигена вируса гепатита В (HBsAg-ИФА-БЕСТ) по ТУ 9398-332-23548172-2012» (комплект 1/авто) №3

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

Хусаинов М.Д.

2022 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия

«Набор реагентов для иммуноферментного выявления HBs-антигена вируса гепатита В (HBsAg-ИФА-БЕСТ) по ТУ 9398-332-235-48172-2012» (комплект 1/авто) №4

Генеральный директор

АО «Вектор-Бест»

Хусаинов М.Д.

2022 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
«Набор реагентов для иммуноферментного выявления HBs-антигена вируса гепатита В (HBsAg-ИФА-БЕСТ) по ТУ 9398-332-23548172-2012» (комплект 1/авто) №5

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

Хусаинов М.Д.

03 2022 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия

«Набор реагентов для иммуноферментного выявления HBs-антигена вируса гепатита В (HBsAg-ИФА-БЕСТ) по IY 9398-332-23548172-2012» (комплект 1/авто) №6

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

Хусанов М.Д.

2022 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия


«Набор реагентов для иммуноферментного выявления HBs-антигена вируса гепатита В (HBsAg-ИФА-БЕСТ) по ТУ 9398-332-23548172-2012» (комплект 1/авто) №7

Генеральный директор

АО «Вектор-Бест»

Хусаинов М.Д.

21 10 2022 г.

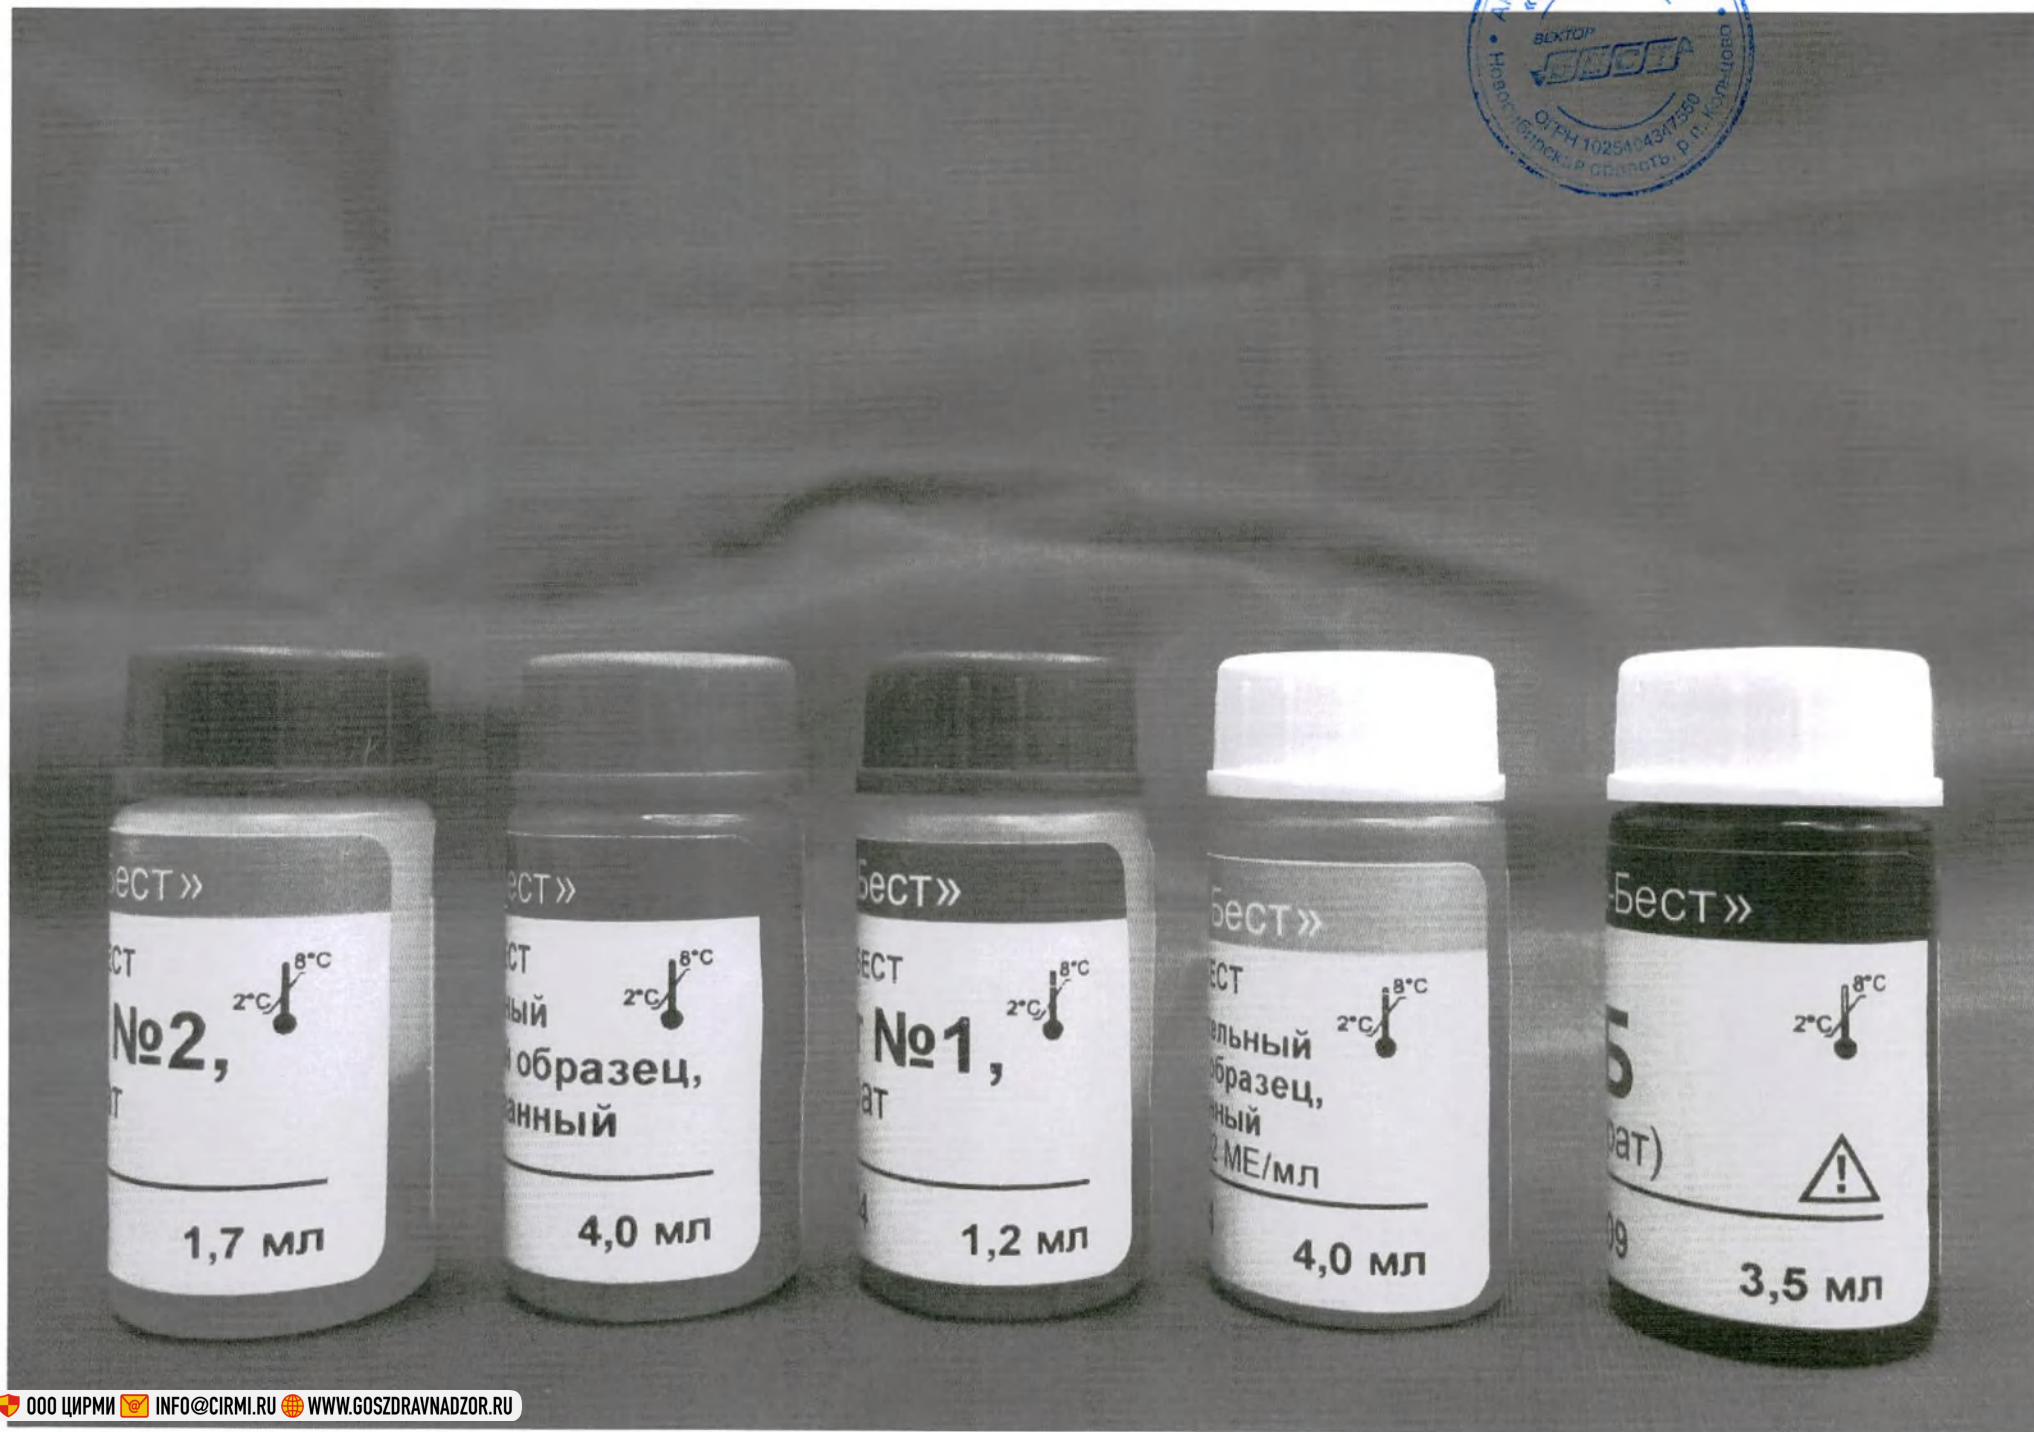


«Набор реагентов для иммуноферментного выявления HBs-антигена вируса гепатита В (HBsAg-ИФА-БЕСТ) по ТУ 9398-332-23548172-2012» (комплект 2)

АО «Вектор-Бест»

Хусаинов М.Д.

« 24 » 103 2022 г.

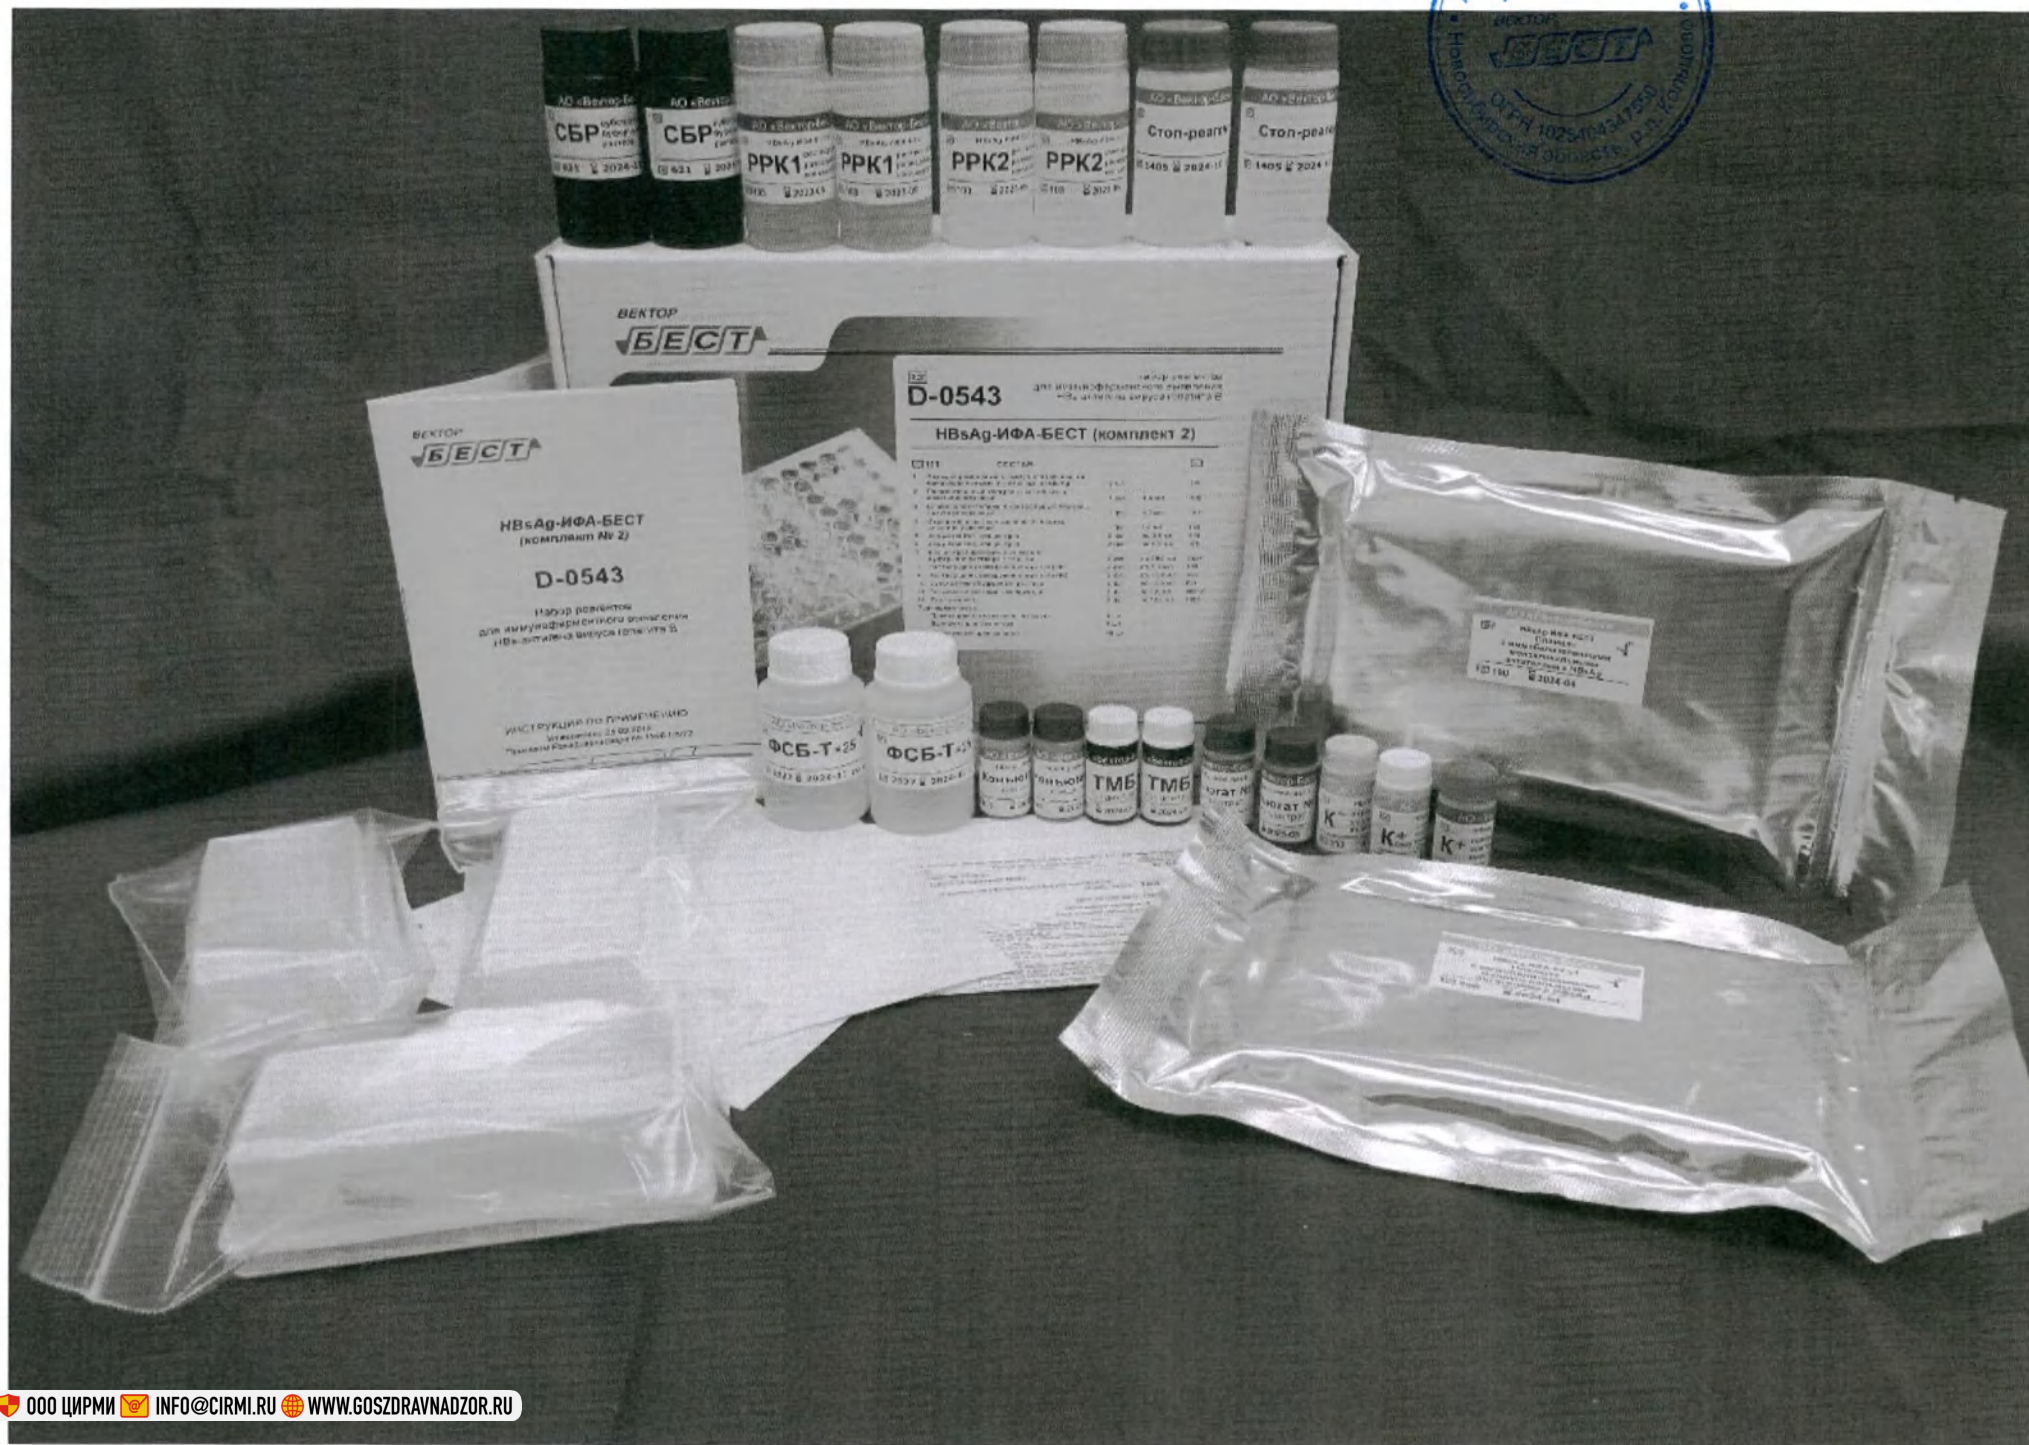

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия

«Набор реагентов для иммуноферментного выявления HBs-антигена вируса гепатита В (HBsAg-ИФА-БЕСТ) по ТУ 9398-332-23548172-2012» (комплект 2) №1

Генеральный директор

АО «Вектор-Бест»

Хусаинов М.Д.

2022 г.



ВЕКТОР

БЕСТ

REF

D-0543

набор реагентов
для иммуноферментного выявления
HBs-антигена вируса гепатита В

HBsAg-ИФА-БЕСТ (комплект 2)

103

СОСТАВ:

103

1. Планшет разборный с иммобилизованными моноклональными антителами к HBsAg	2 шт.	190
2. Положительный контрольный образец, инактивированный	1 фл. 1,0 мл	103
3. Слабоположительный контрольный образец, инактивированный	1 фл. 1,0 мл	103
4. Отрицательный контрольный образец, инактивированный	1 фл. 1,0 мл	103
5. Конъюгат №1, концентрат	2 фл. по 0,8 мл	103
6. Конъюгат №2, концентрат	2 фл. по 1,5 мл	103
7. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с танином	2 фл. по 28,0 мл	2927
8. Раствор для разведения конъюгата №1	2 фл. по 7,0 мл	103
9. Раствор для разведения конъюгата №2	2 фл. по 13,0 мл	103
10. Субстратный буферный раствор	2 фл. по 13,0 мл	621
11. Тетраметилбензидин, концентрат	2 фл. по 1,0 мл	40607
12. Стоп-реагент	2 фл. по 12,0 мл	1406

Принадлежности:

Пленка для заклеивания планшета	4 шт.
Ванночка для реагентов	6 шт.
Наконечники для пипеток	48 шт.

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия

«Набор реагентов для иммуноферментного выявления HBs-антигена вируса гепатита В (HBsAg-ИФА-БЕСТ) по ТУ 9398-332-23548172-2012» (комплект 2) №2


Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

Хусаинов М.Д.

2022 г.



ВЕКТОР
БЕСТ

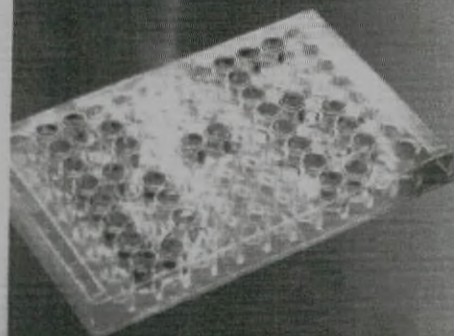

REF **D-0543**

Σ 2x96

LOT

103

ТУ 9398-332-23548172-2012

ПУ № ФСР 2012/13925 от 25.03.2017

2021-11-26

2022-11-26

HBsAg-ИФА-БЕСТ (комплект 2)

IVD



05432611220010300636

Антитела к ВИЧ-1,2 и вирусу гепатита С отсутствуют


Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия

«Набор реагентов для иммуноферментного выявления HBs-антигена вируса гепатита В (HBsAg-ИФА-БЕСТ) по ТУ 9398-332-23548172-2012» (комплект 2) №1

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

Хусаинов М.Д.

«21» 10с 2022 г.

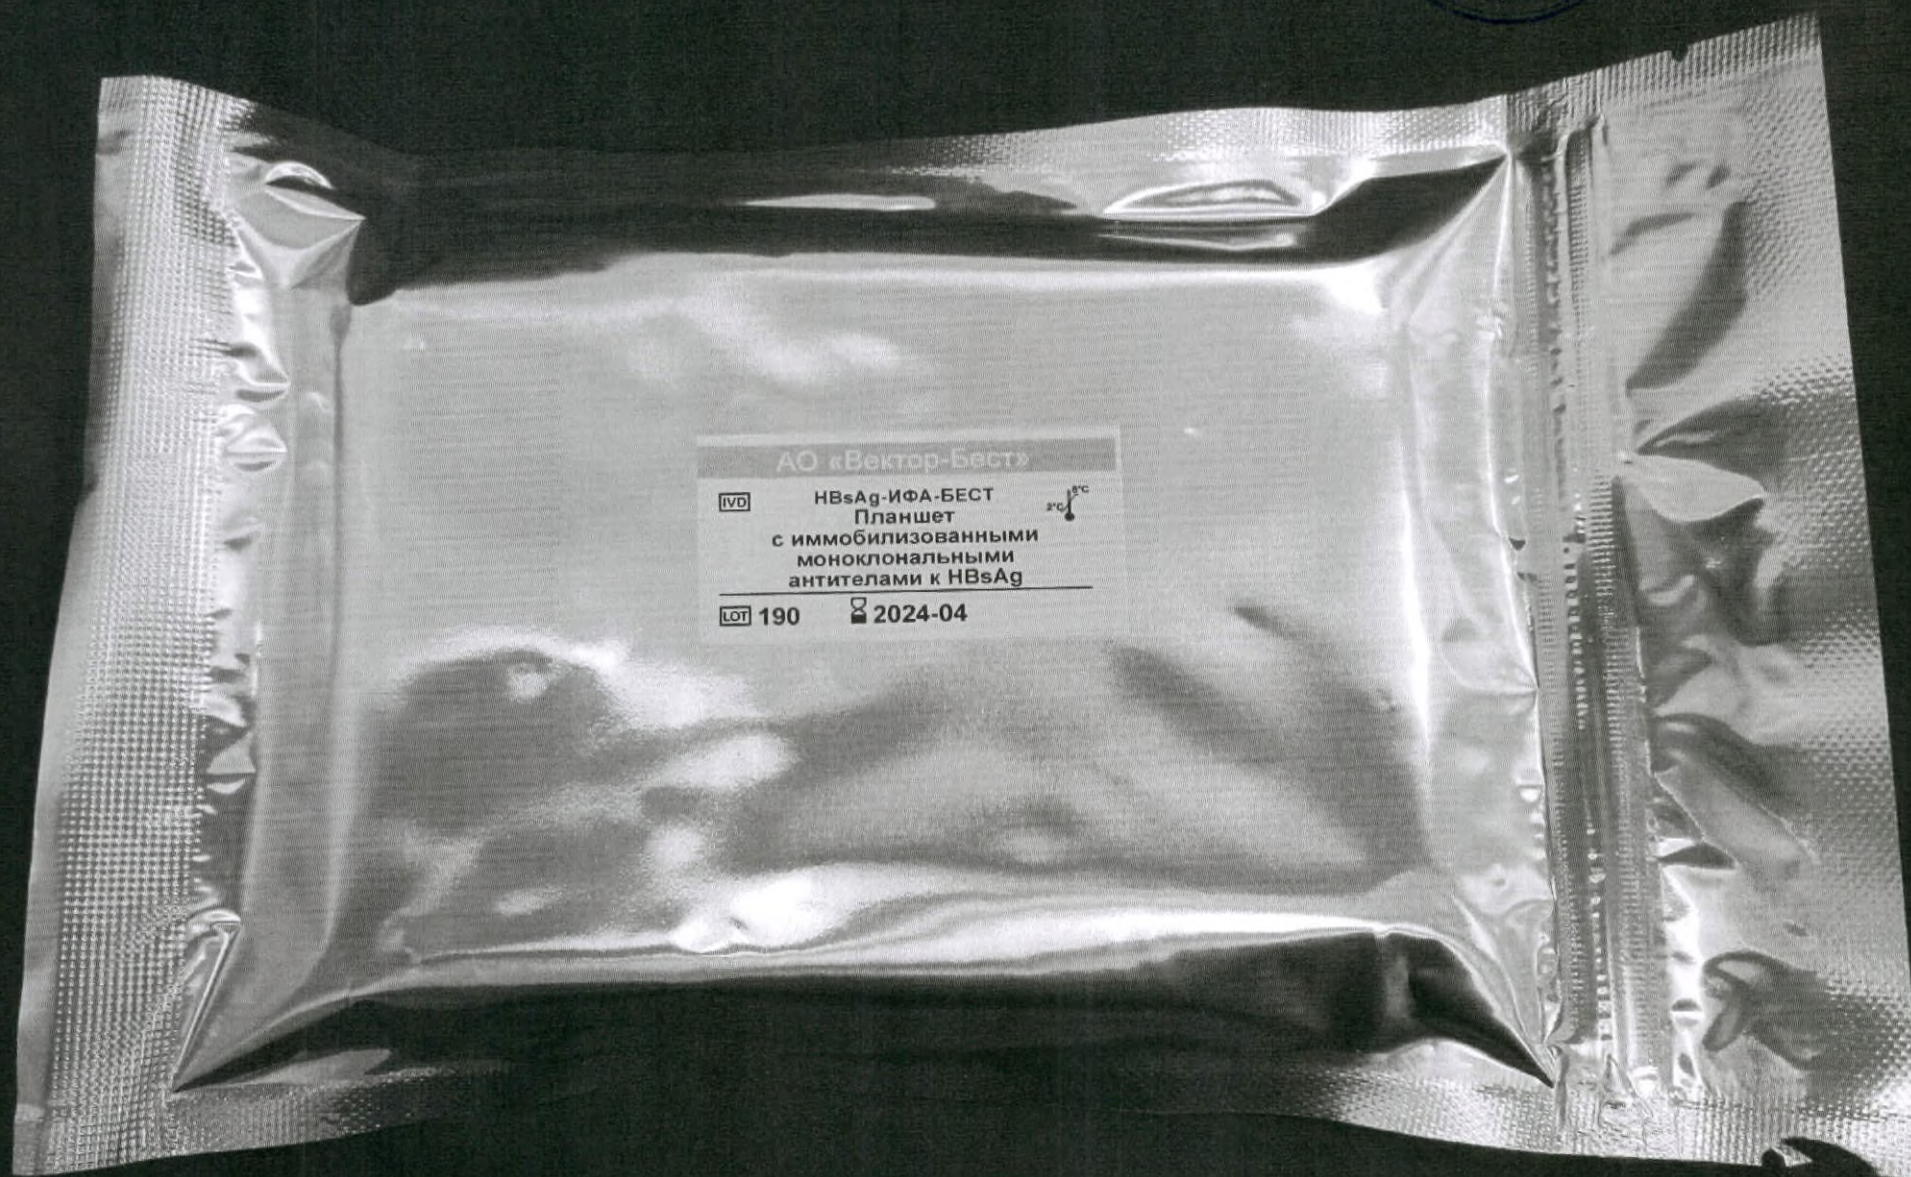

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия


«Набор реагентов для иммуноферментного выявления HBs-антигена вируса гепатита В (HBsAg-ИФА-
Ы С Г) по ТУ 9398-332-23548172-2012» (комплект 2) №2





Генеральный директор

АО «Вектор-Бест»

Хусаинов М.Д.

«24» 01 2022 г.

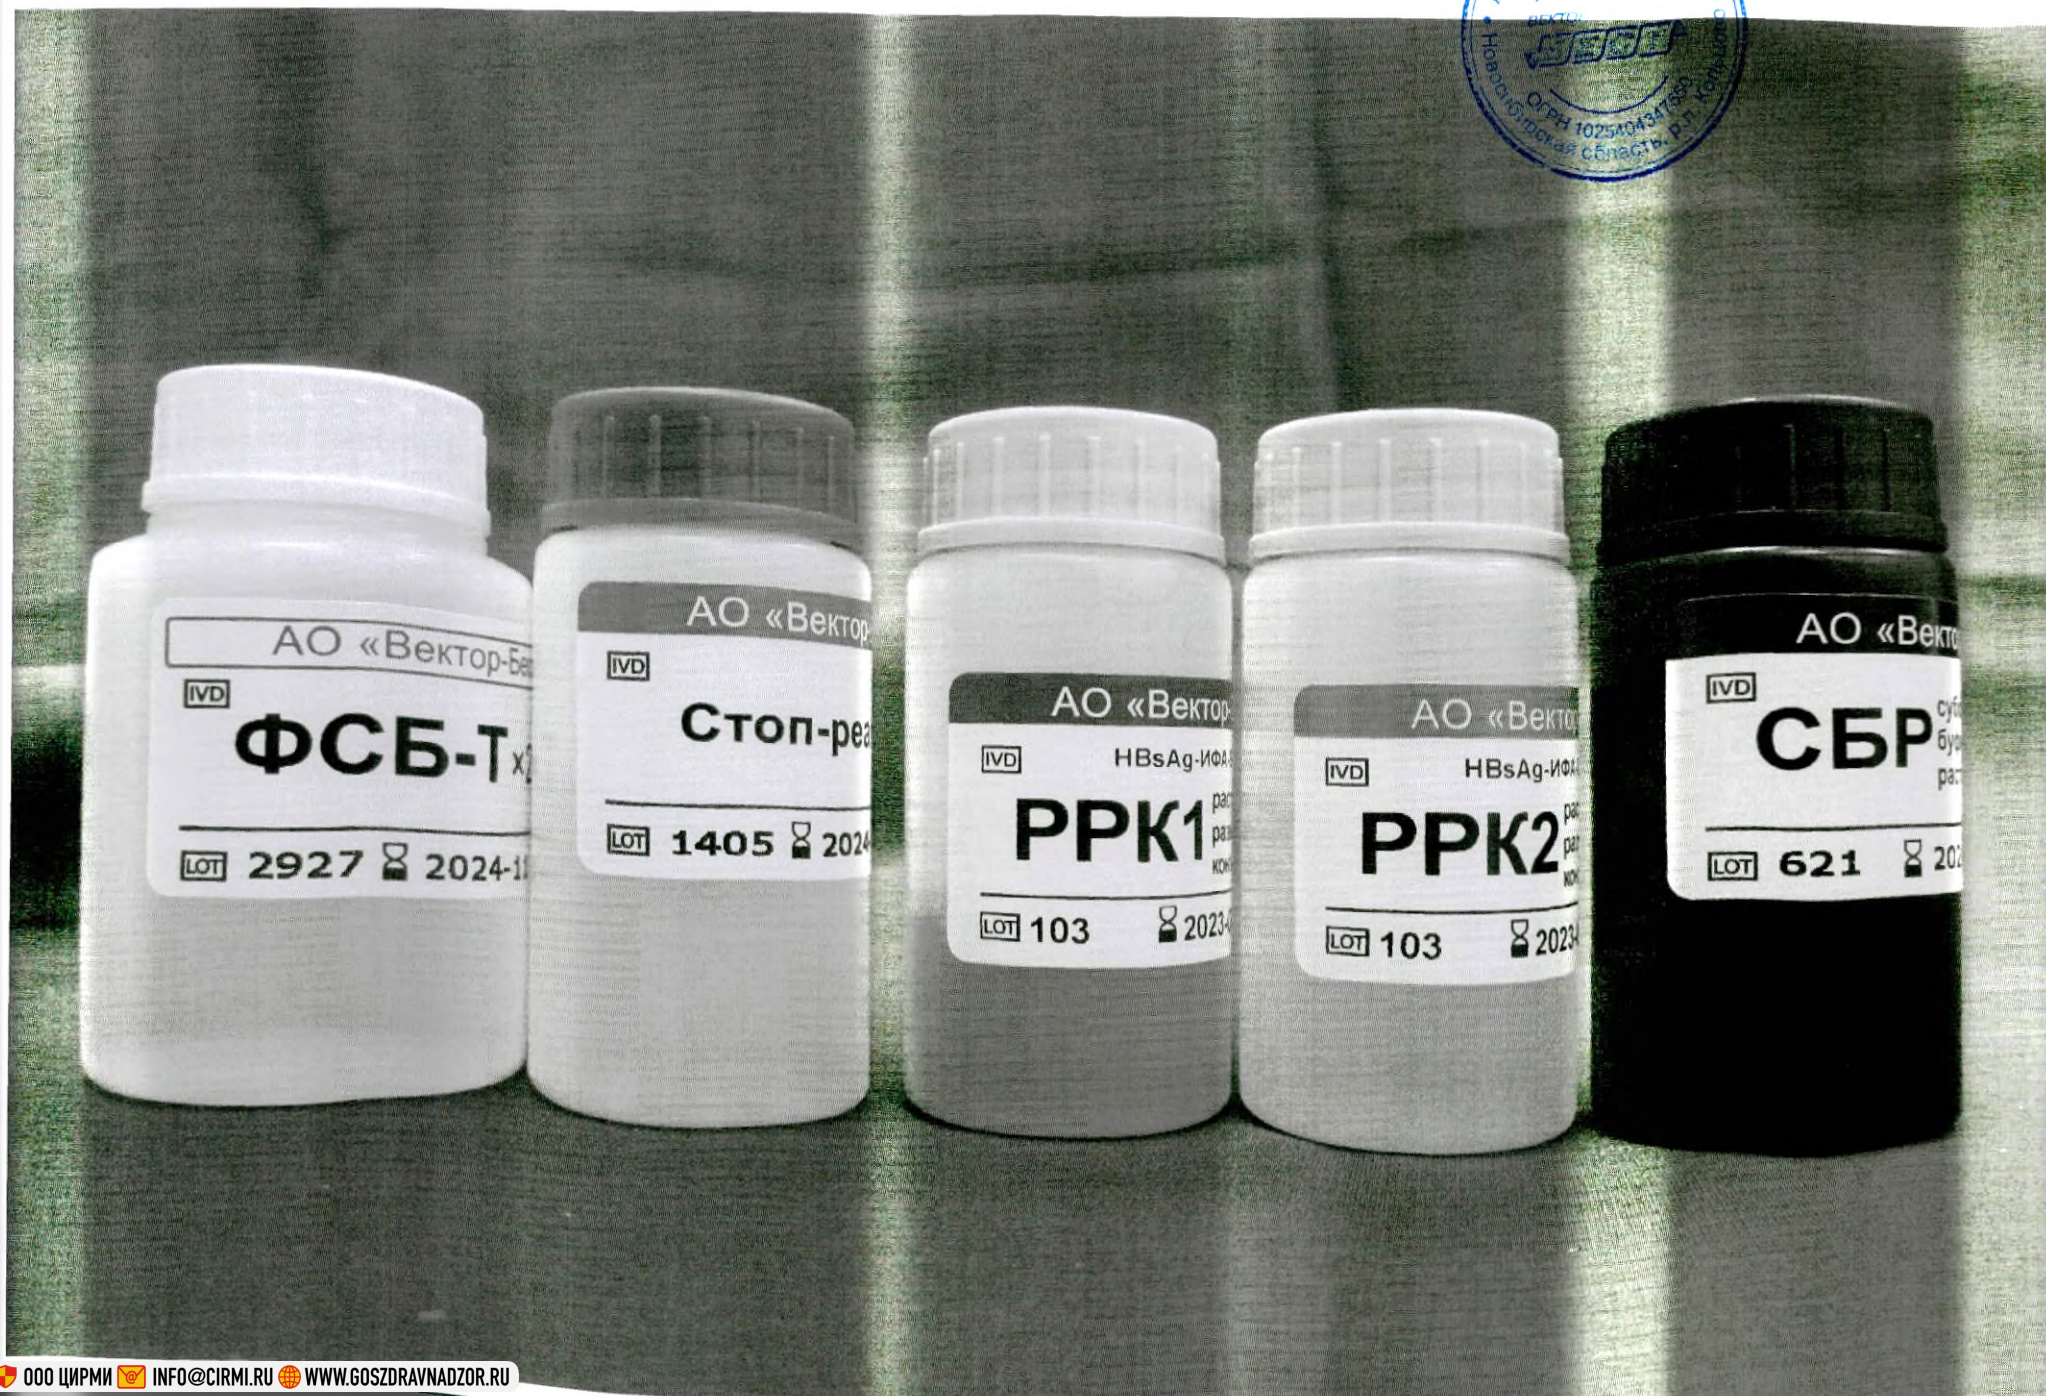

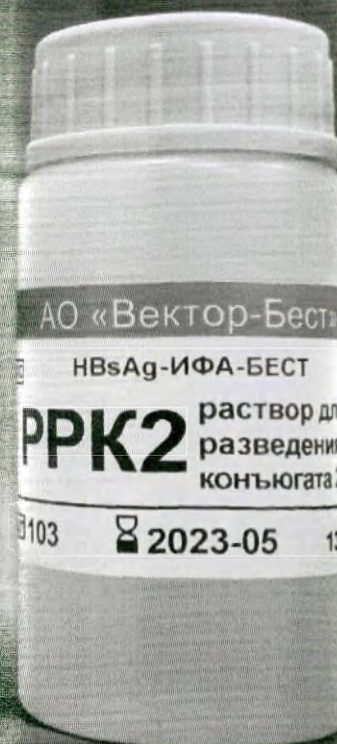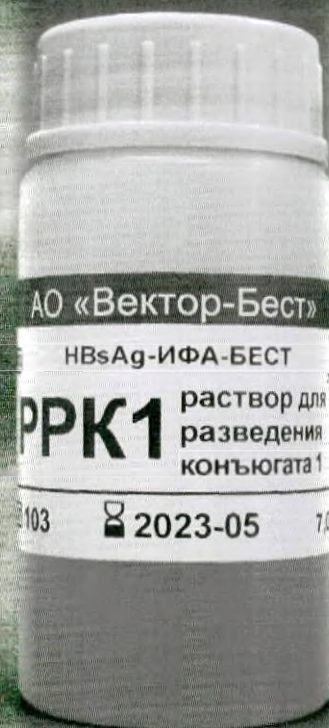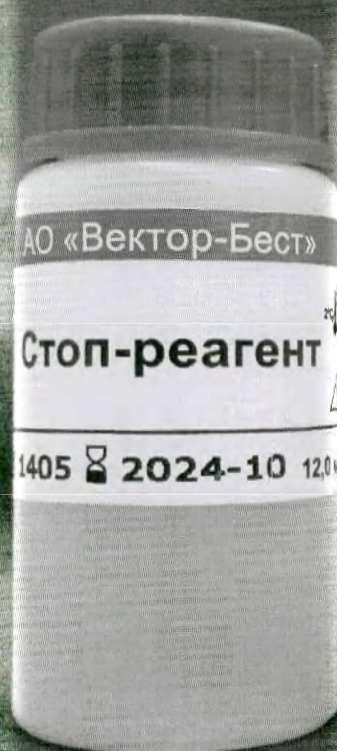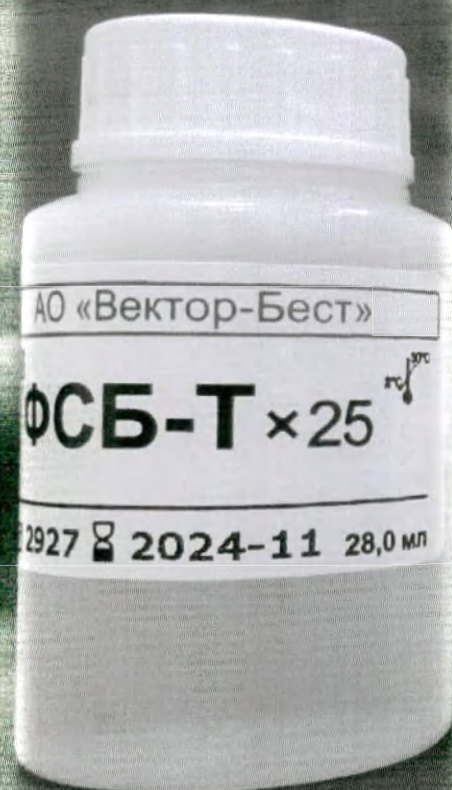

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия

«Набор реагентов для иммуноферментного выявления HBs-антигена вируса гепатита В (HBsAg-ИФА-БЕСТ) по ТУ 9398-332-23548172-2012» (комплект 2) №4

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

Хусаинов М.Д.

2022 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия

«Набор реагентов для иммуноферментного выявления HBs-антигена вируса гепатита В (HBsAg-ИФА-БЕСТ) по ТУ 9398-332-23548172-2012» (комплект 2) №5

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

Хусаинов М.Д.

2022 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия

«Набор реагентов для иммуноферментного выявления HBs-антигена вируса гепатита В (HBsAg-ИФА-ИФГ) по ТУ 9398-332-235481-2012» (комплект 2) №6

Генеральный директор

АО «Вектор-Бест»



Хусаинов М.Д.

03 2022



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия

«Набор реагентов для иммуноферментного выявления HBs-антигена вируса гепатита В (HBsAg-ИФА-БЕСТ) по ТУ 9398-332-23548172-2012» (комплект 2) №7

Генеральный директор

АО «Вектор-Бест»

Хусаинов М.Д.

03 2022 г.




Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия

«Набор реагентов для иммуноферментного выявления HBs-антигена вируса гепатита В (HBsAg-ИФА-БЕСТ) по ТУ 9398-332-23548172-2012» (комплект 3)

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

Хусаинов М.Д.

2022 г.

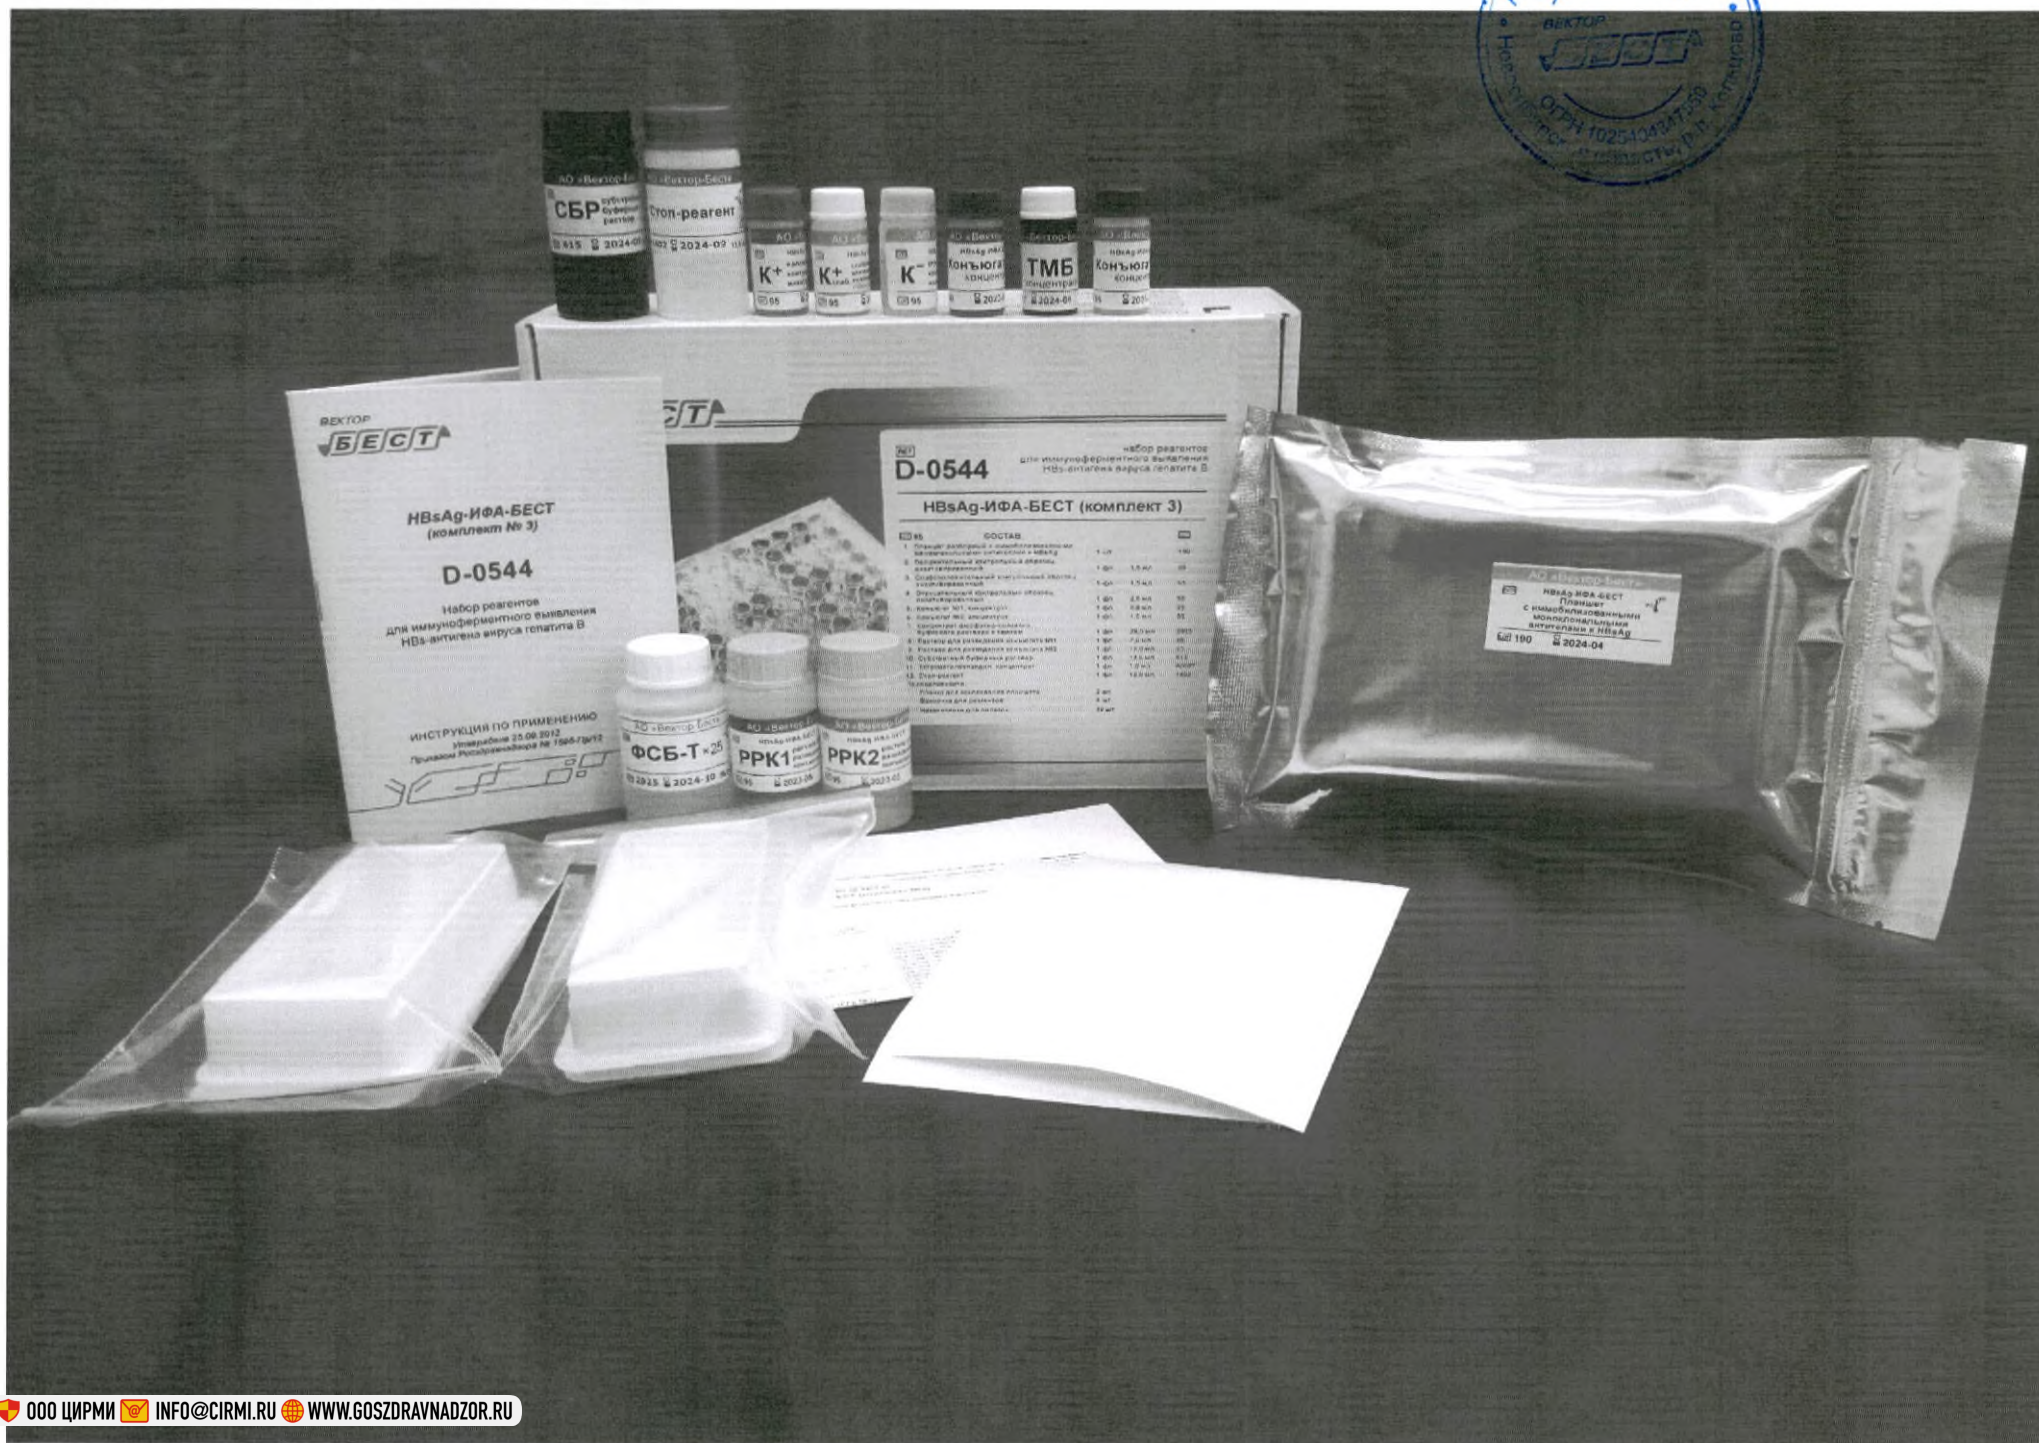

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия

«Набор реагентов для иммуноферментного выявления HBs-антигена вируса гепатита В (HBsAg-ИФА-БЕСТ) по ТУ 9398-332-23548172-2012» (комплект 3) №1

Генеральный директор

АО «Вектор-Бест»

Хусаинов М.Д.

2013 2022 г.



ВЕКТОР

БЕСТ

REC

D-0544

набор реагентов
для иммуноферментного выявления
HBs-антигена вируса гепатита В

HBsAg-ИФА-БЕСТ (комплект 3)

95

СОСТАВ:

95

1. Планшет разборный с иммобилизованными моноклональными антителами к HBsAg	1 шт.	190
2. Положительный контрольный образец, инактивированный	1 фл. 1,5 мл	95
3. Слабоположительный контрольный образец, инактивированный	1 фл. 1,5 мл	95
4. Отрицательный контрольный образец, инактивированный	1 фл. 2,5 мл	95
5. Конъюгат №1, концентрат	1 фл. 0,8 мл	95
6. Конъюгат №2, концентрат	1 фл. 1,5 мл	95
7. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином	1 фл. 28,0 мл	2925
8. Раствор для разведения конъюгата №1	1 фл. 7,0 мл	95
9. Раствор для разведения конъюгата №2	1 фл. 13,0 мл	95
10. Субстратный буферный раствор	1 фл. 13,0 мл	615
11. Тетраметилбензидин, концентрат	1 фл. 1,0 мл	40607
12. Стол-реагент	1 фл. 12,0 мл	1402
Принадлежности:		
Пленка для заклеивания планшета	2 шт.	
Ванночка для реагентов	4 шт.	
Наконечники для пипетки	32 шт.	

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия

«Набор реагентов для иммуноферментного выявления HBs-антигена вируса гепатита В (HBsAg-ИФА-БЕСТ) по ТУ 9398-332-23548172-2012» (комплект 3) №2

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»


Хусаинов М.Д.

2022 г.



ВЕКТОР

БЕСТ

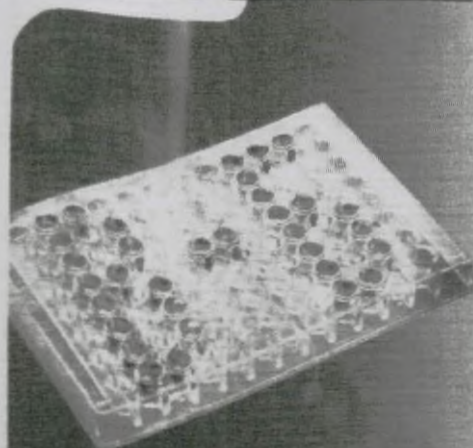

REF **D-0544**

Σ 12x8

LOT

95

ТУ 9398-332-23548172-2012

РУ № ФСР 2012/13925 от 25.03.2017



2021-11-22



2022-11-22

HBsAg-ИФА-БЕСТ (комплект 3)

IVD



05442211220009500715

Антитела к ВИЧ-1,2 и вирусу гепатита С отсутствуют

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия

«Набор реагентов для иммуноферментного выявления HBs-антигена вируса гепатита В (HBsAg-ИФА-БЕСТ) по ТУ 9398-332-23548172-2012» (комплект 3) №1

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

Хусаинов М.Д.

«21» 103 2022 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия


«Набор реагентов для иммуноферментного выявления HBs-антигена вируса гепатита В (HBsAg-ИФА-БЕСТ) по ТУ 9398-332-23548172-2012» (комплект 3) №2

Генеральный директор

АО «Вектор-Бест»

Хусаинов М.Д.

2022 г.

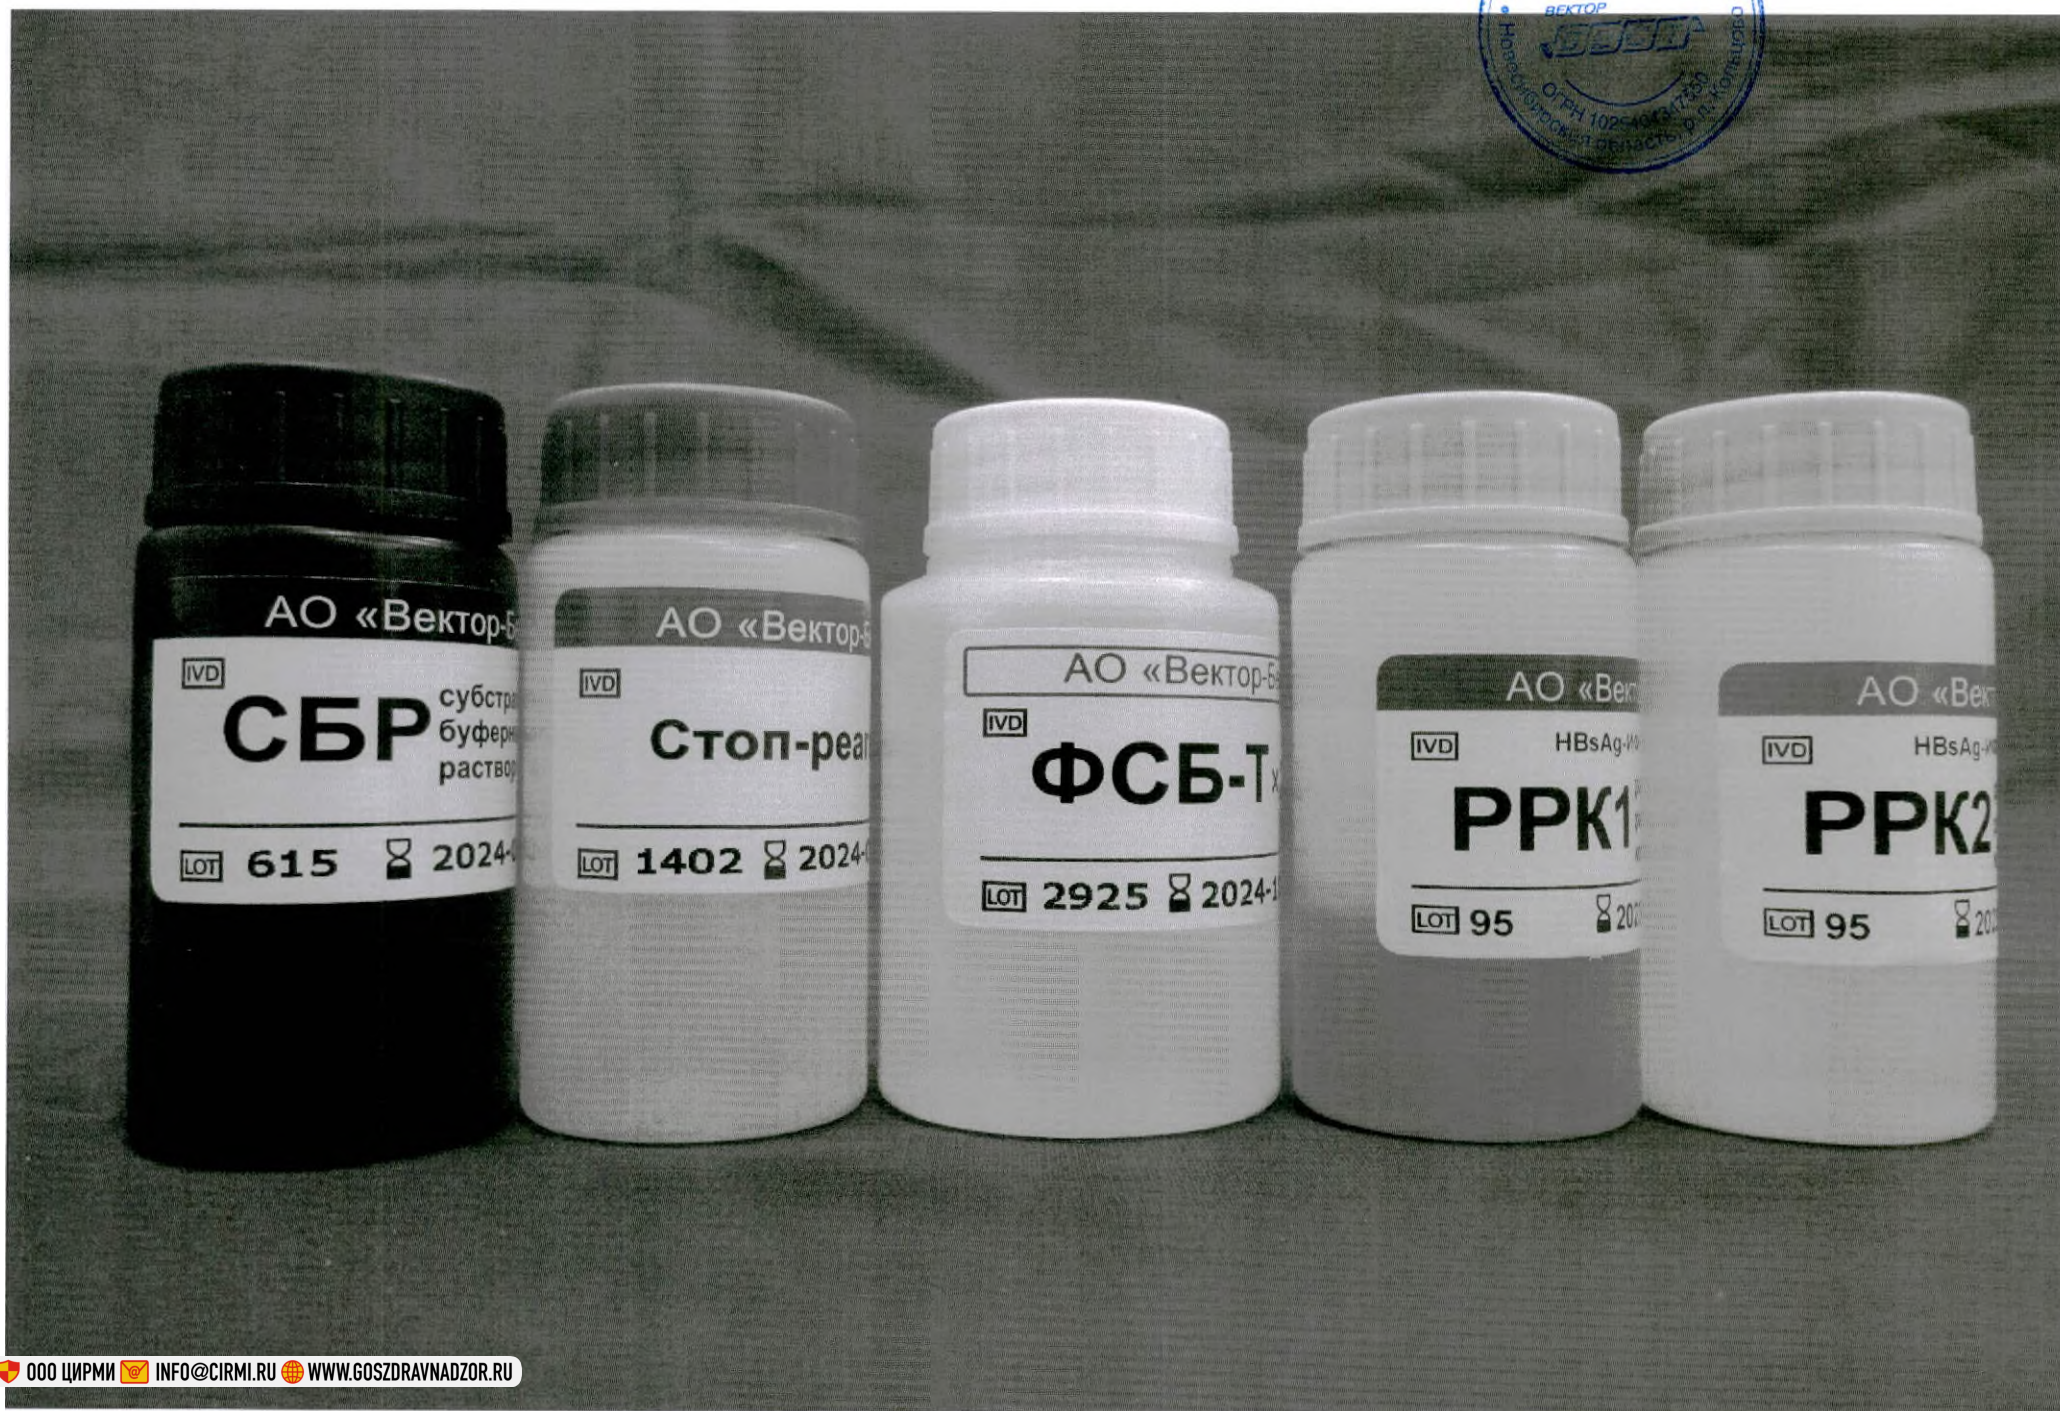

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия

«Набор реагентов для иммуноферментного выявления HBs-антигена вируса гепатита В (HBsAg-ИФА-БЕСТ) по ТУ 9398-332-23548172-2012» (комплект 3) №3

Генеральный директор

АО «Вектор-Бест»

Хусаинов М.Д.

2022 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия

«Набор реагентов для иммуноферментного выявления HBs-антигена вируса гепатита В (HBsAg-ИФА-БЕСТ) по ТУ 9398-332-23548172-2012» (комплект 3) №4

Генеральный директор

АО «Вектор-Бест»

Хусаинов М.Д.

2022 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия


«Набор реагентов для иммуноферментного выявления HBs-антигена вируса гепатита В (HBsAg-ИФА-БЕСТ) по ТУ 9398-332-23548172-2012» (комплект 3) №5

Генеральный директор

АО «Вектор-Бест»

Хусаинов М.Д.

«24» 05 2022 г.

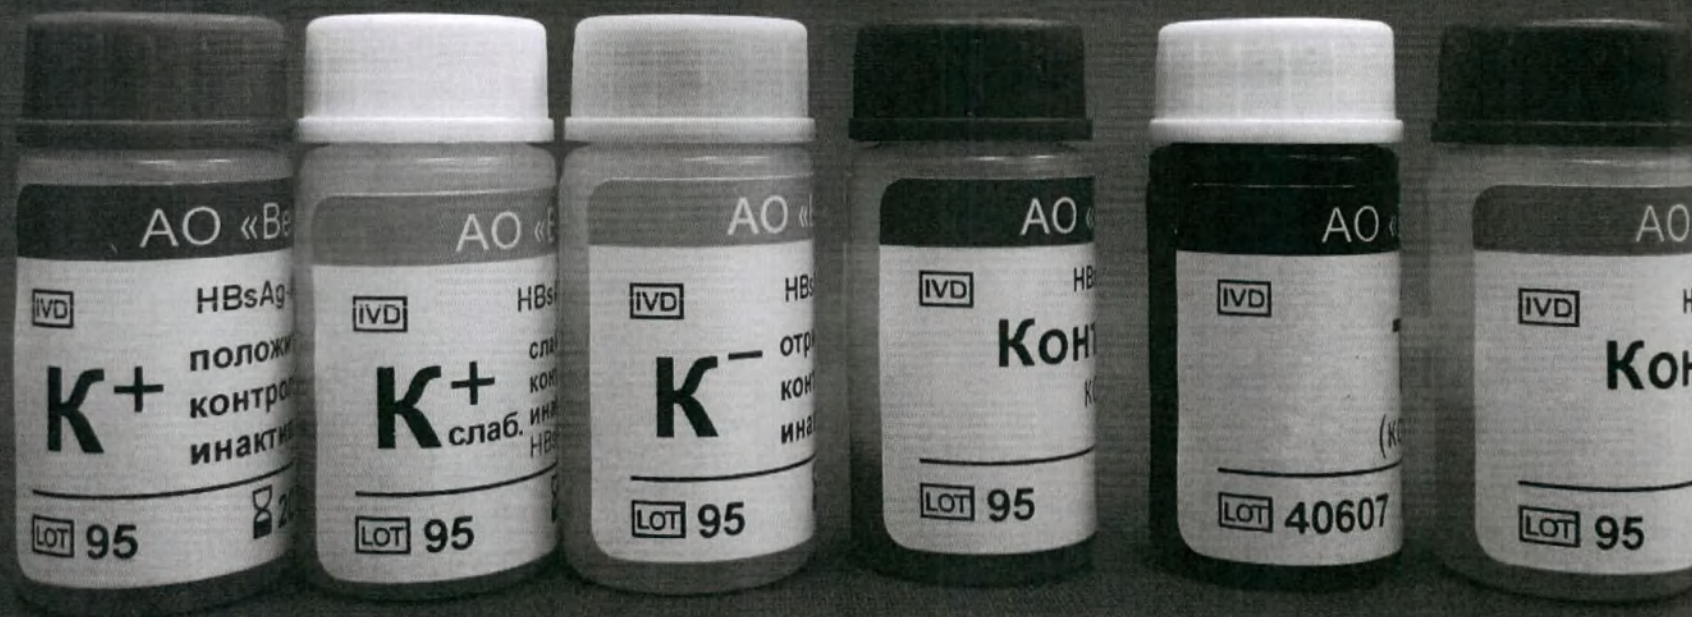

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия

«Набор реагентов для иммуноферментного выявления HBs-антигена вируса гепатита В (HBsAg-ИФА-БЕСТ) по ТУ 9398-332-23548172-2012» (комплект 3) №6

Генеральный директор

АО «Вектор-Бест»

Хусаинов М.Д.

2022 г.





2022 г.

