


Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
 «Набор реагентов для иммуноферментного количественного и качественного определения иммуноглобулинов класса G к цитомегаловирусу в сыворотке (плазме) крови (ЦМВ-IgG-ИФА-БЕСТ) по ТУ 9398-335-23548172-2012»

Генеральный директор
 АО «Вектор-Бест»




Хусаинов М.Д.
 «01» 04 2022 г.

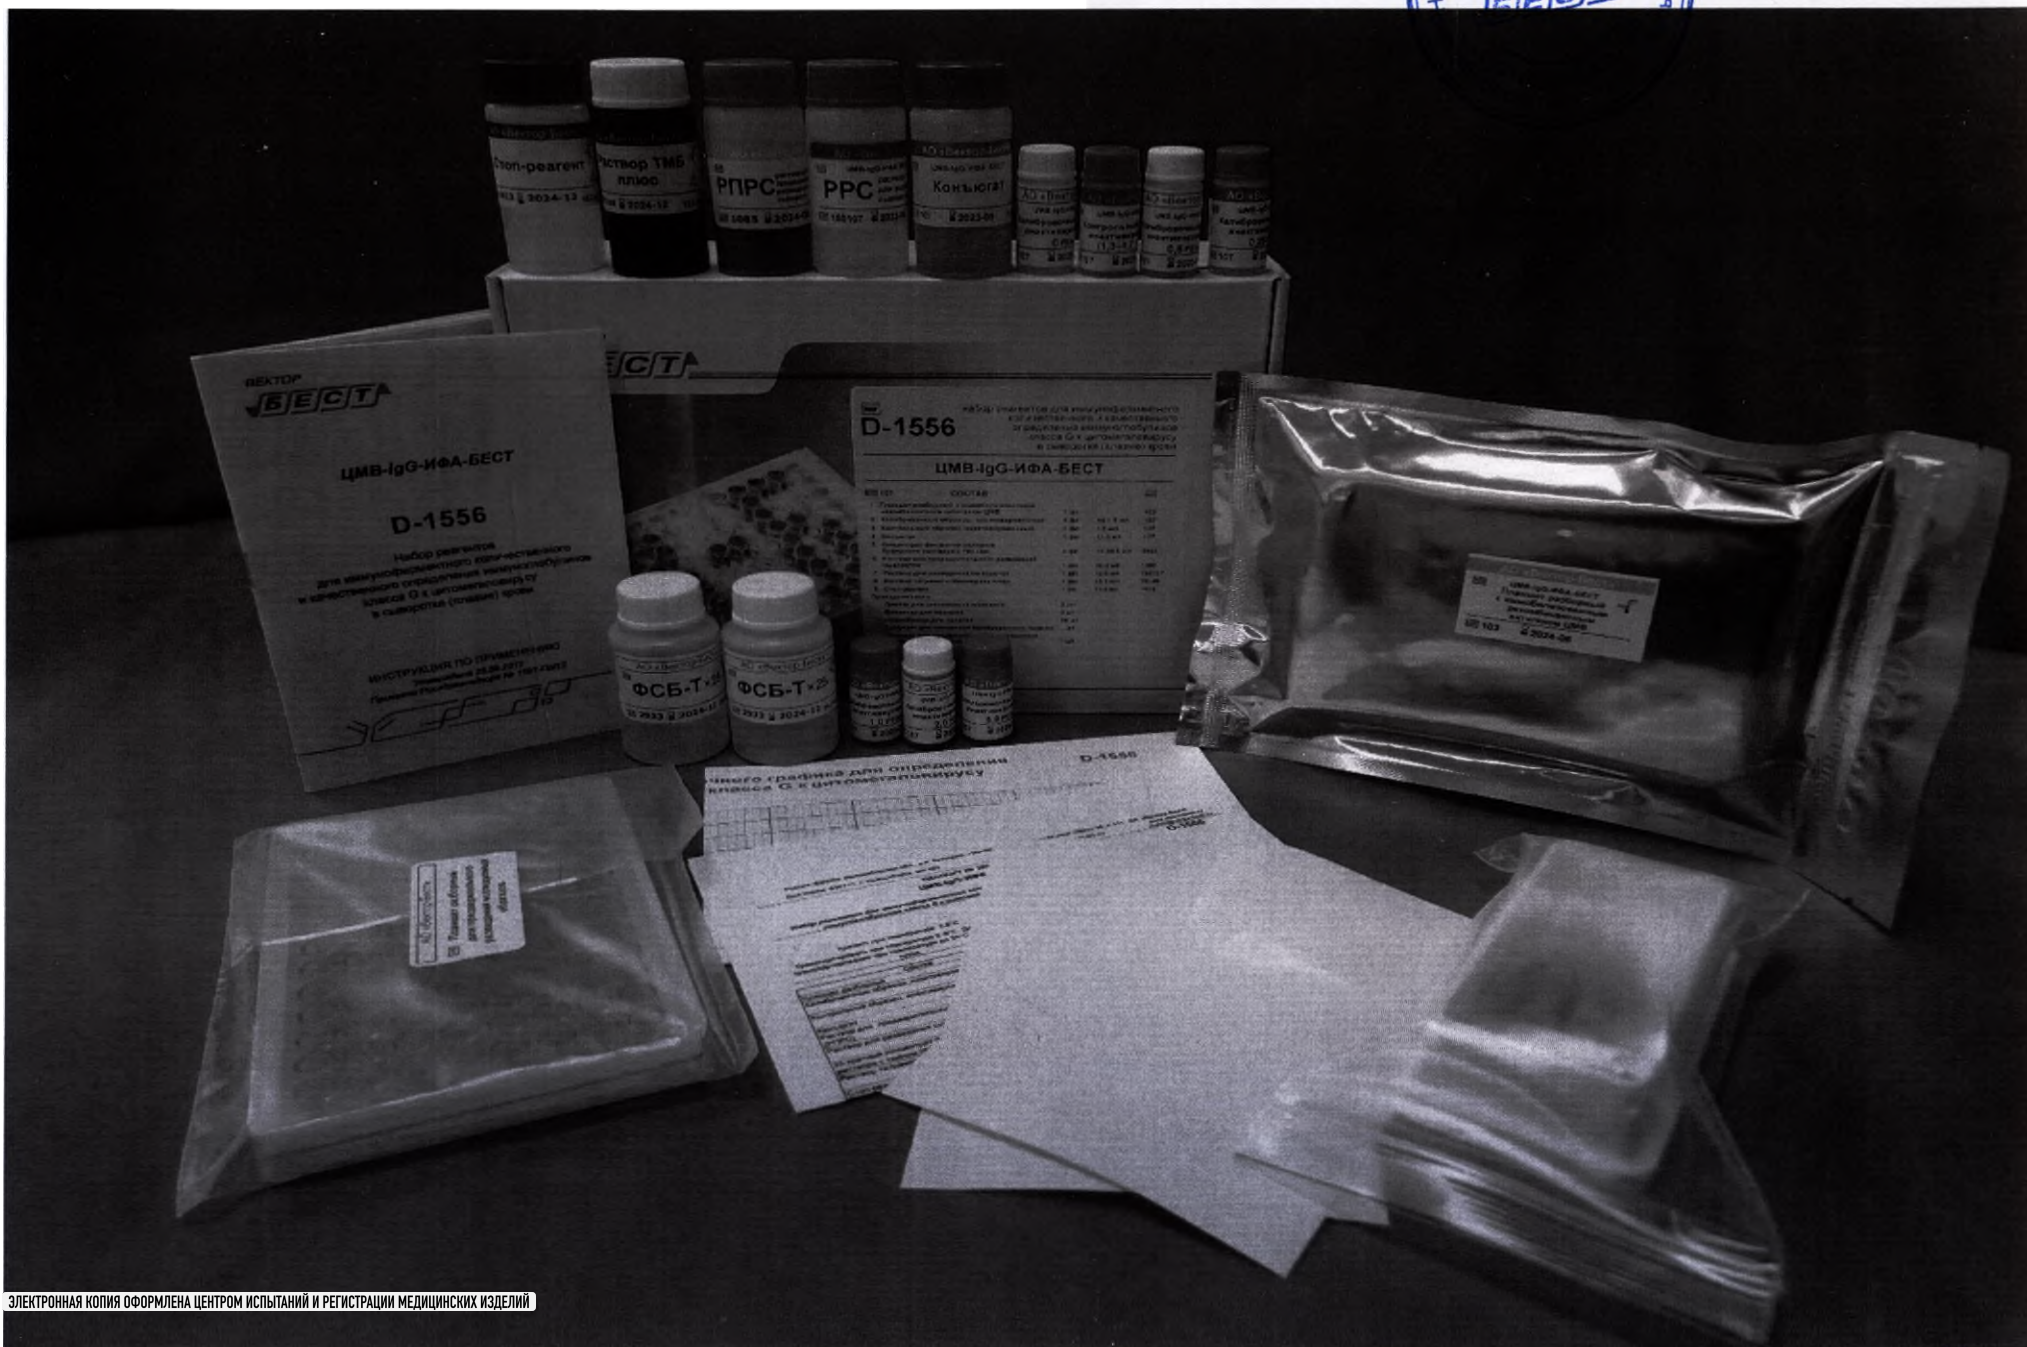

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
«Набор реагентов для иммуноферментного количественного и качественного определения иммуноглобулинов класса G к цитомегаловирусу в сыворотке (плазме) крови (ЦМВ-IgG-ИФА-БЕСТ) по ТУ 9398-335-23548172-2012» №1

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

Хусаинов М.Д.
«07» 04 2022 г.

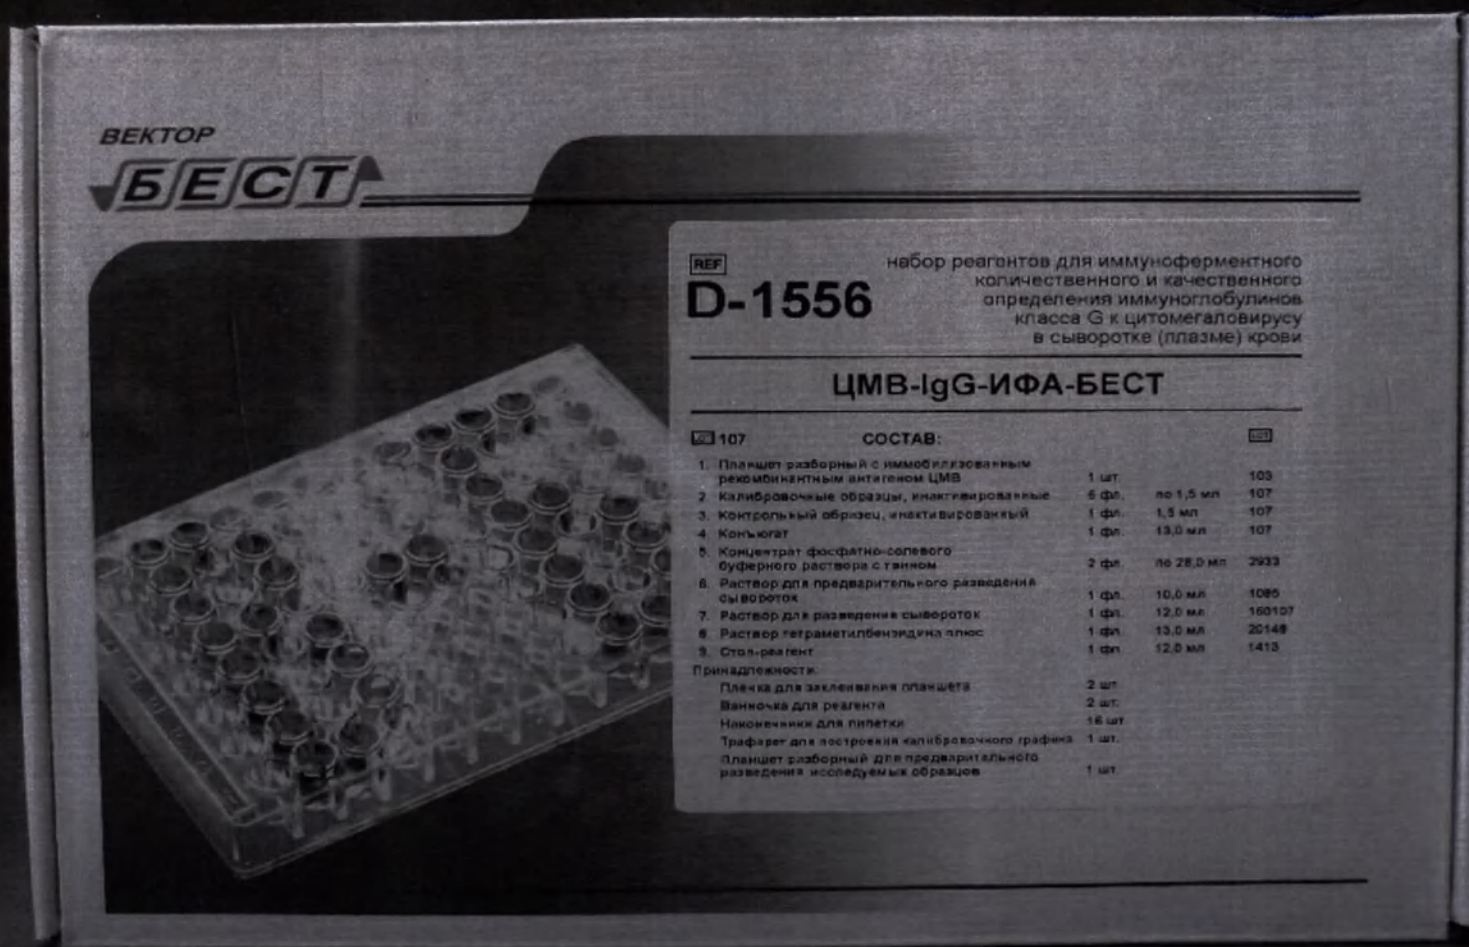

REF
D-1556
набор реагентов для иммуноферментного
количественного и качественного
определения иммуноглобулинов
класса G к цитомегаловирусу
в сыворотке (плазме) крови

ЦМВ-IgG-ИФА-БЕСТ

№ 107	СОСТАВ:	№ 103
1. Планшет разборный с иммобилизованным рекомбинантным антигеном ЦМВ	1 шт.	103
2. Калибровочные образцы, инактивированные	6 фла. по 1,5 мл	107
3. Контрольный образец, инактивированный	1 фла. 1,5 мл	107
4. Конъюгат	1 фла. 13,0 мл	107
5. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с танном	2 фла. по 25,0 мл	2933
6. Раствор для предварительного разведения сывороток	1 фла. 10,0 мл	1095
7. Раствор для разведения сывороток	1 фла. 12,0 мл	160107
8. Раствор тетраметилбензидина плюс	1 фла. 13,0 мл	20149
9. Стоп-реагент	1 фла. 12,0 мл	1413
Принадлежности:		
Пленка для закрепления планшета	2 шт.	
Ванночка для реагента	2 шт.	
Наконечники для пипетки	16 шт.	
Трафарет для построения калибровочного графика	1 шт.	
Планшет разборный для предварительного разведения исследуемых образцов	1 шт.	

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
«Набор реагентов для иммуноферментного количественного и качественного определения иммуноглобулинов класса G к цитомегаловирусу в сыворотке (плазме) крови (ЦМВ-IgG-ИФА-БЕСТ) по ТУ 9398-335-23548172-2012» №2

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

Хусанов М.Д.

2022 г.




Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия

«Набор реагентов для иммуноферментного количественного и качественного определения иммуноглобулинов класса G к цитомегаловирусу в сыворотке (плазме) крови (ЦМВ-IgG-ИФА-БЕСТ) по ТУ 9398-335-23548172-2012» №1

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»



Хусаинов М.Д.
2022 г.

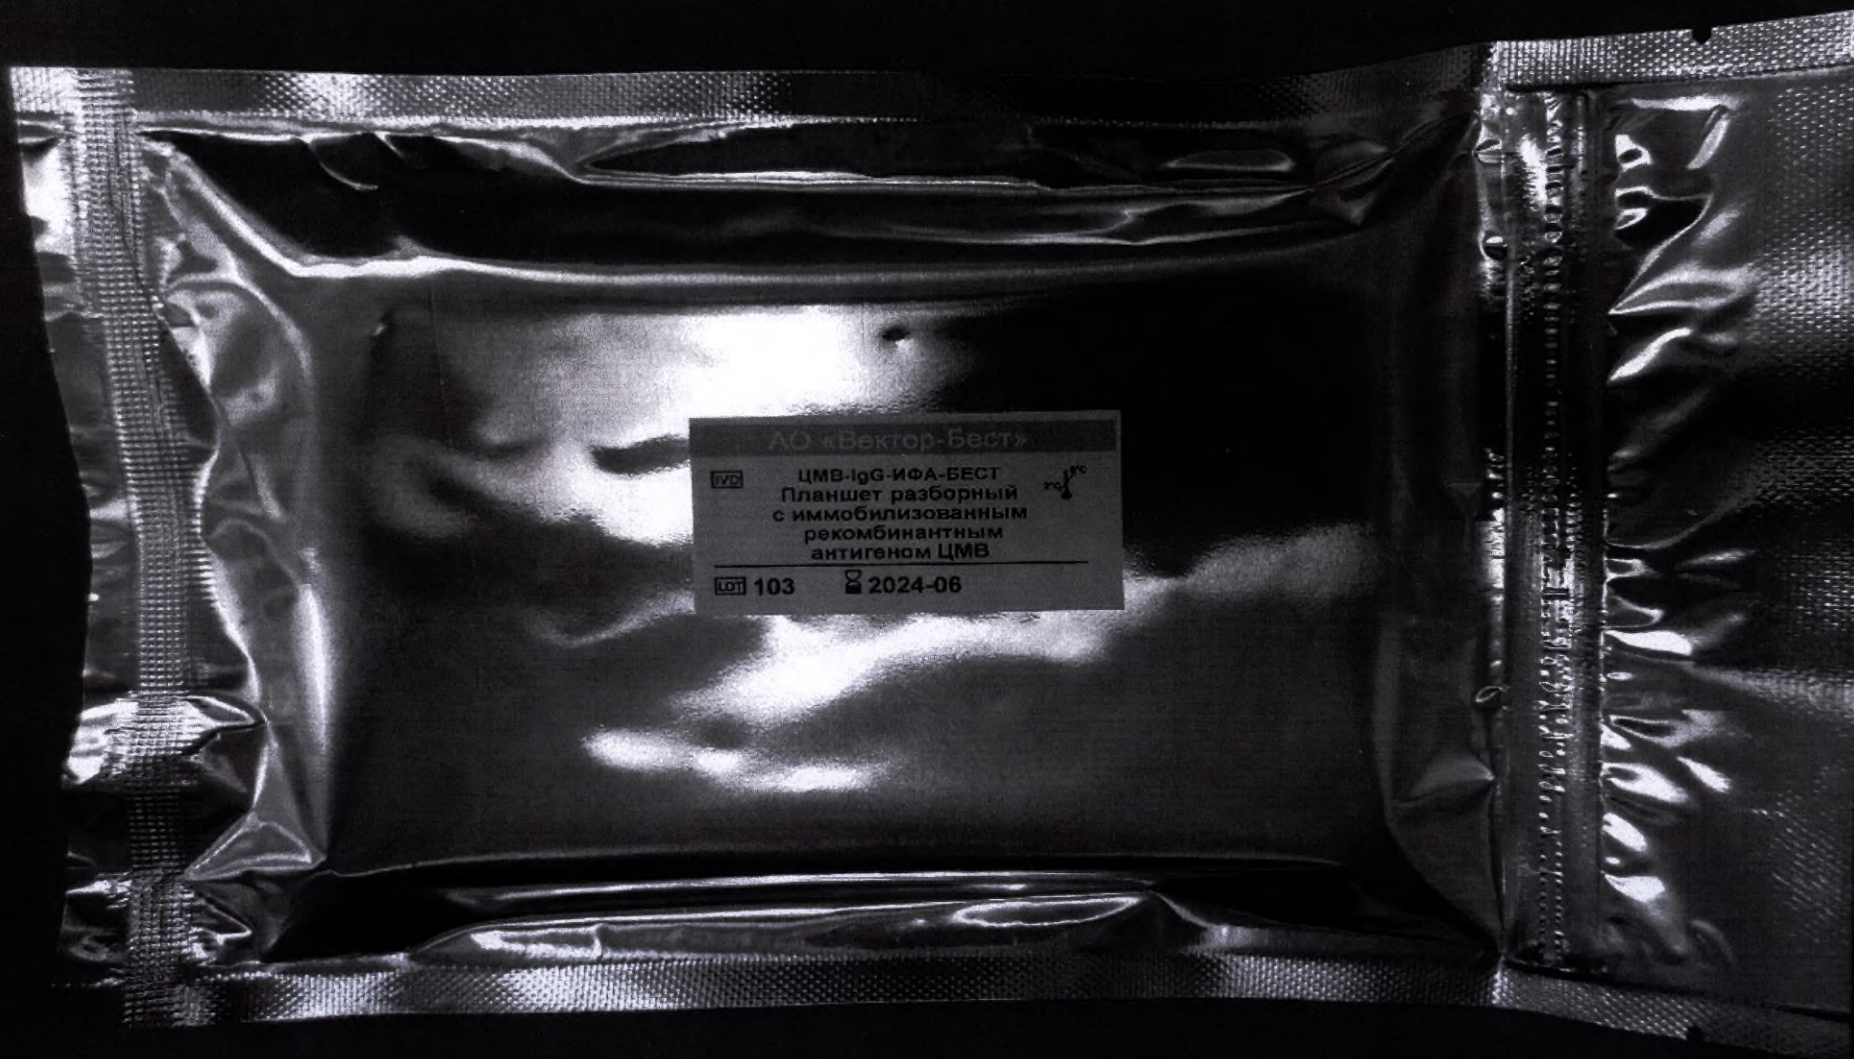

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
«Набор реагентов для иммуноферментного количественного и качественного определения иммуноглобулинов класса G к цитомегаловирусу в сыворотке (плазме) крови (ЦМВ-IgG-ИФА-БЕСТ) по ТУ 9398-335-23548172-2012» №2

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест» _____ Хусаинов М.Д.
2022 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
«Набор реагентов для иммуноферментного количественного и качественного определения иммуноглобулинов класса G к цитомегаловирусу в сыворотке (плазме) крови (ЦМВ-IgG-ИФА-БЕСТ) по ТУ 9398-335-23548172-2012» №3

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

Хусаинов М.Д.

2022 г.




Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
«Набор реагентов для иммуноферментного количественного и качественного определения иммуноглобулинов класса G к цитомегаловирусу в сыворотке (плазме) крови (ЦМВ-IgG-ИФА-БЕСТ) по ТУ 9398-335-23548172-2012» №4

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

Хусаинов М.Д.



2022 г.

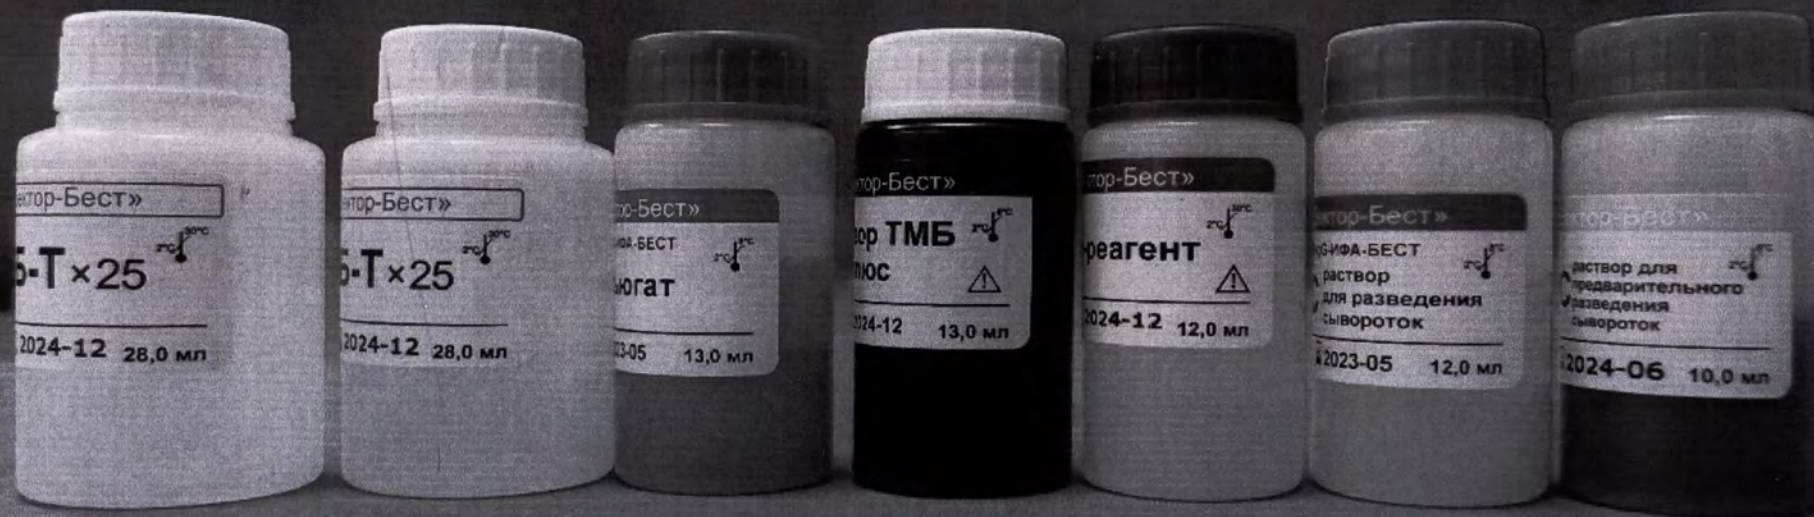

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
«Набор реагентов для иммуноферментного количественного и качественного определения
иммуноглобулинов класса G к цитомегаловирусу в сыворотке (плазме) крови (ЦМВ-IgG-ИФА-БЕСТ) по
ТУ 9398-335-23548172-2012» №5

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

Хусаинов М.Д.
2022 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
«Набор реагентов для иммуноферментного количественного и качественного определения
иммуноглобулинов класса G к цитомегаловирусу в сыворотке (плазме) крови (ЦМВ-IgG-ИФА-БЕСТ) по
ТУ 9398-335-23548172-2012» №6

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»



Хусаинов М.Д.

2022 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия

«Набор реагентов для иммуноферментного количественного и качественного определения иммуноглобулинов класса G к цитомегаловирусу в сыворотке (плазме) крови (ЦМВ-IgG-ИФА-БЕСТ) по ТУ 9398-335-23548172-2012» №7

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

Хусаинов М.Д.



2022 г.

