

ор

Акционерное общество
«Вектор Бест»


Хусаинов М.Д.

103

2022 г.

ВЕКТОР

БЕСТ

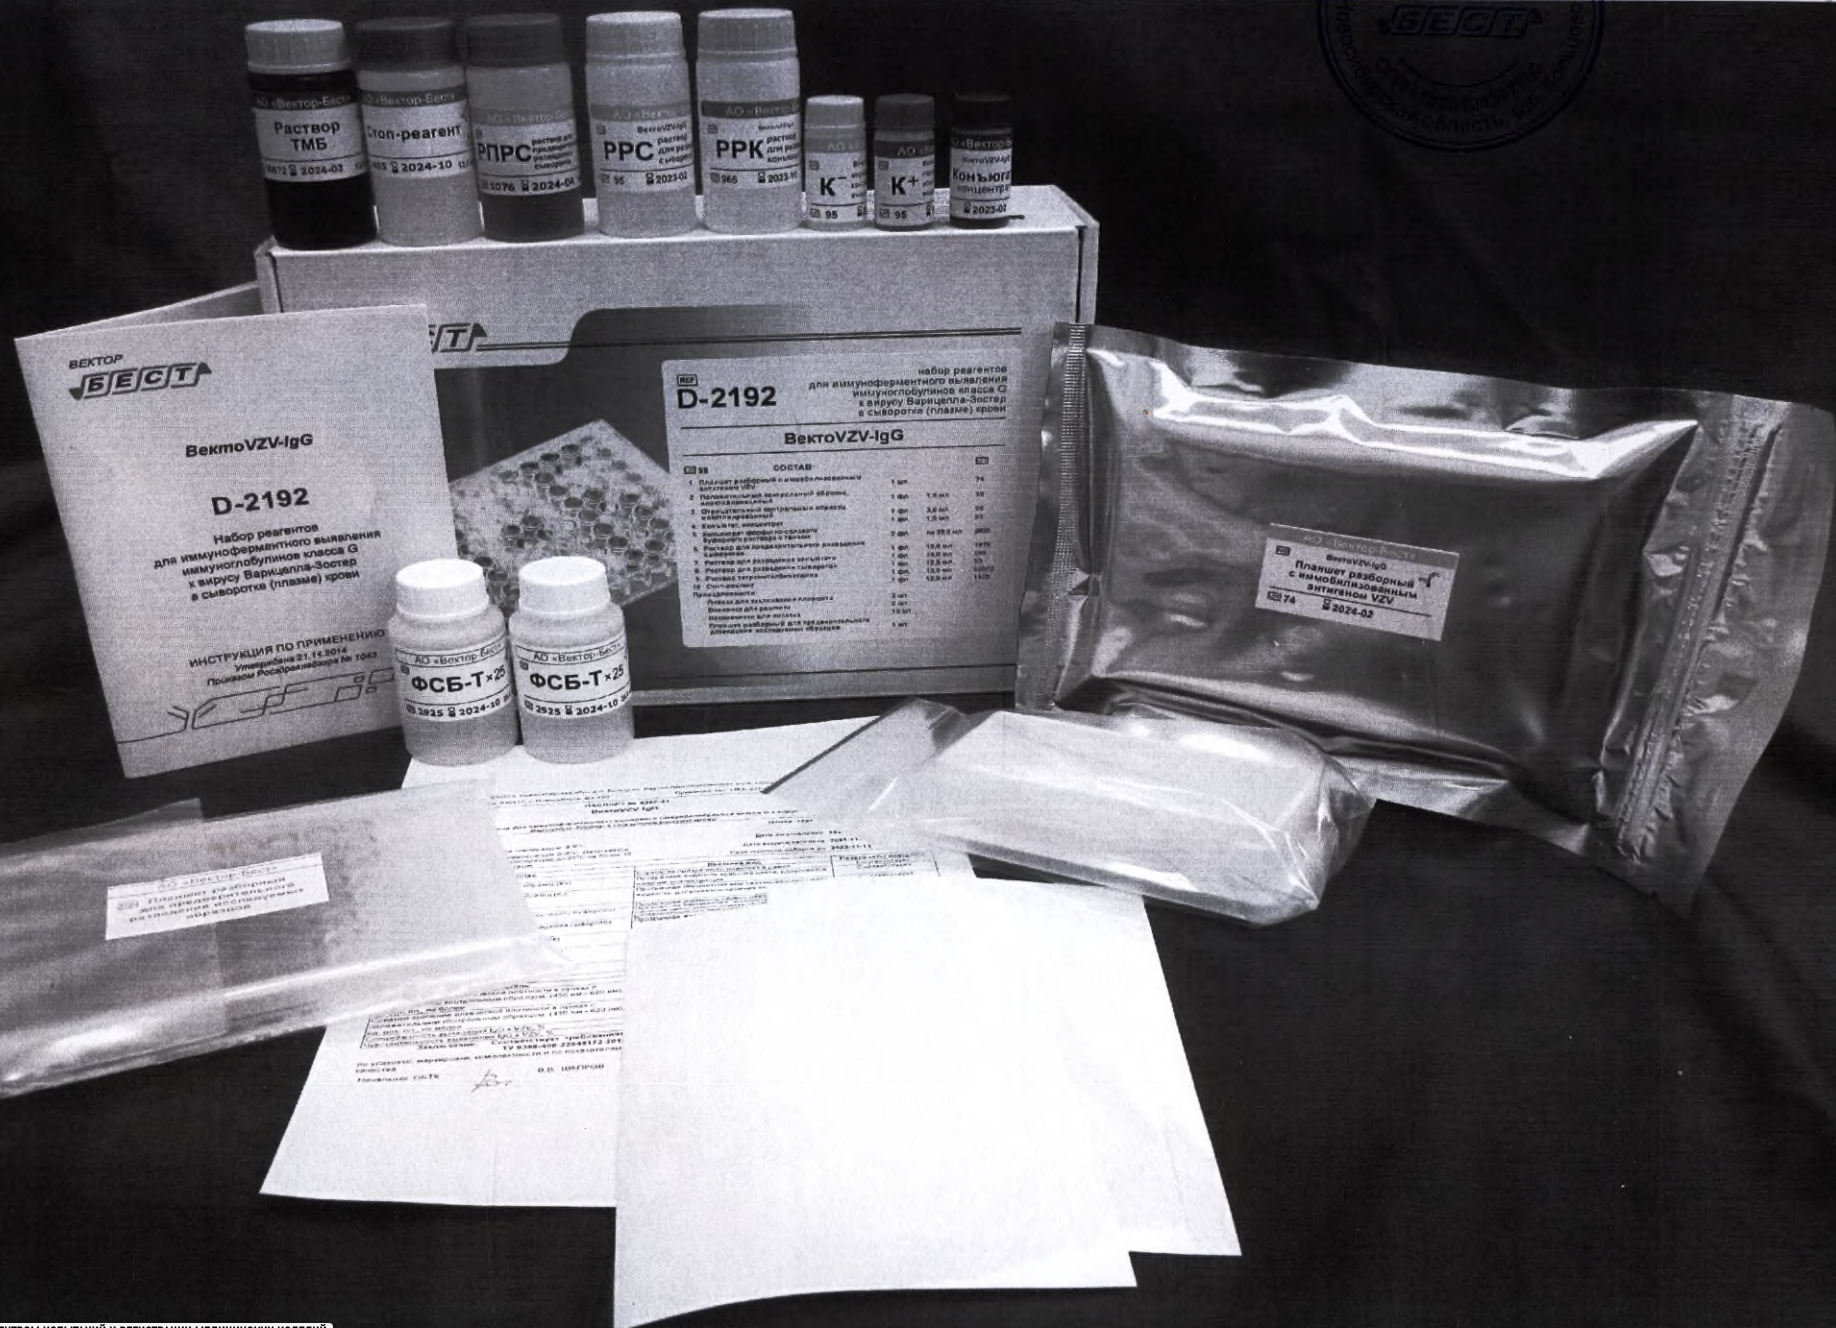

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
«Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу Варицелла-Зостер (IgG к VZV) в сыворотке (плазме) крови (ВектоVZV-IgG) по ТУ 9398-406-23548172-2013» №1

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»



Хусаинов М.Д.
2022 г.

ВЕКТОР

БЕСТ



REF

D-2192

набор реагентов
для иммуноферментного выявления
иммуноглобулинов класса G
к вирусу Варицелла-Зостер
в сыворотке (плазме) крови

ВектоVZV-IgG

КОТ 98

СОСТАВ:

КОТ

1. Планшет разборный с иммобилизованным антигеном VZV	1 шт.	74
2. Положительный контрольный образец, инактивированный	1 фл. 1,5 мл	95
3. Отрицательный контрольный образец, инактивированный	1 фл. 3,0 мл	95
4. Конъюгат, концентрат	1 фл. 1,5 мл	95
5. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином	2 фл. по 28,0 мл	2925
6. Раствор для предварительного разведения сывороток	1 фл. 10,0 мл	1076
7. Раствор для разведения конъюгата	1 фл. 13,0 мл	965
8. Раствор для разведения сывороток	1 фл. 12,0 мл	95
9. Раствор тетраметилбензидина	1 фл. 13,0 мл	30572
10. Стоп-реагент	1 фл. 12,0 мл	1405

Принадлежности:

Пленка для заклеивания планшета	2 шт.
Ванночка для реагента	2 шт.
Наконечники для пипетки	16 шт.
Планшет разборный для предварительного разведения исследуемых образцов	1 шт.


Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия

«Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу Варицелла-Зостер (IgG к VZV) в сыворотке (плазме) крови (ВектоVZV-IgG) по ТУ 9398-406-23548172-2013» №2

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

Хусаинов М.Д.

2022 г.

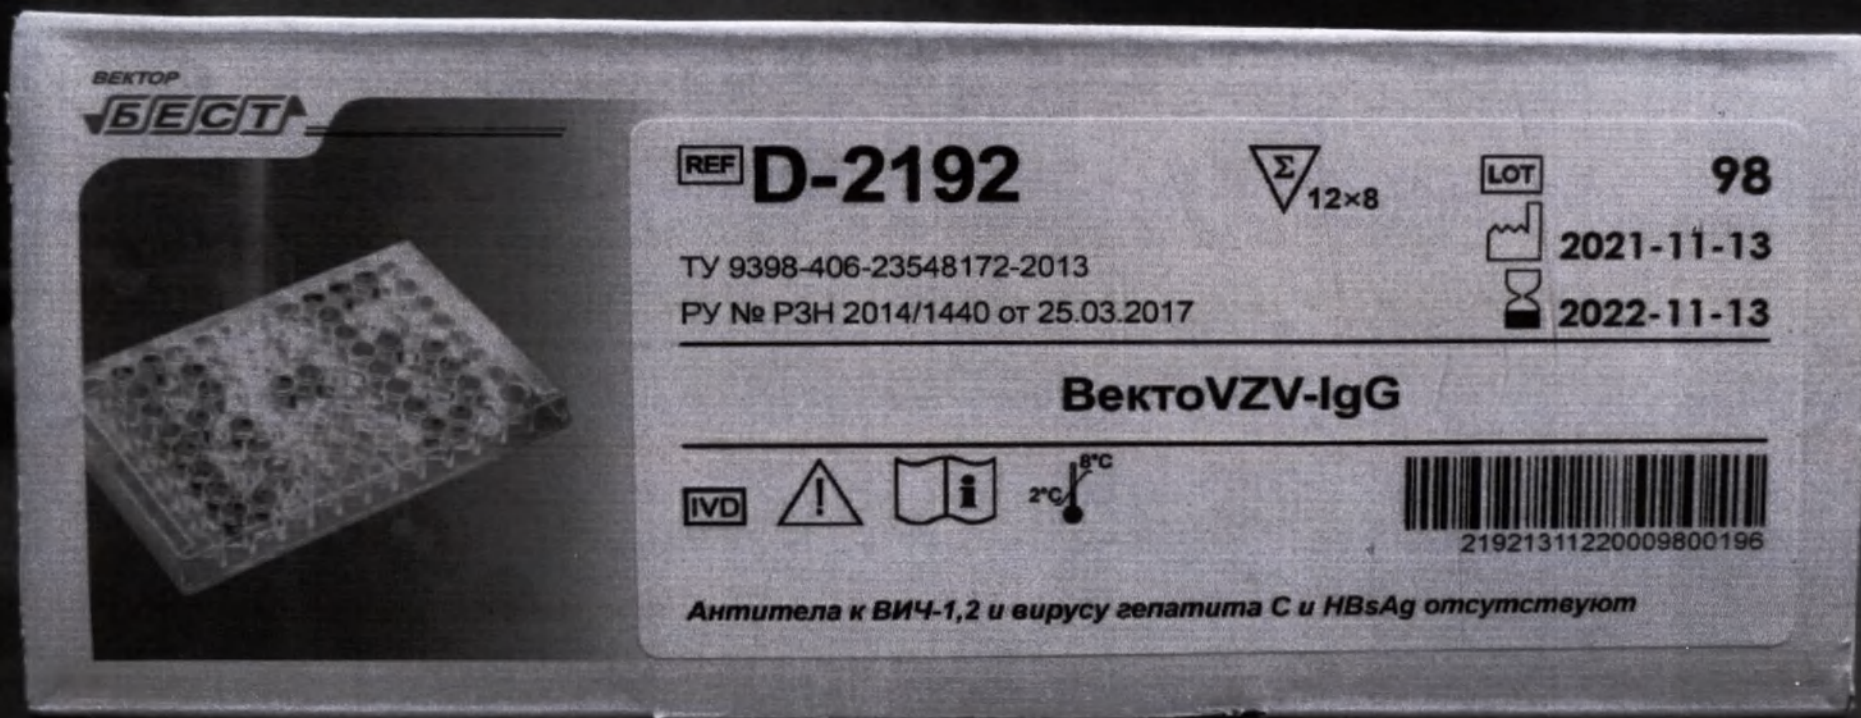


Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
«Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу Варицелла-Зостер (IgG к VZV) в сыворотке (плазме) крови (ВектоVZV-IgG) по ТУ 9398-406-23548172-2013» №1

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»



Хусаинов М.Д.

2022 г.

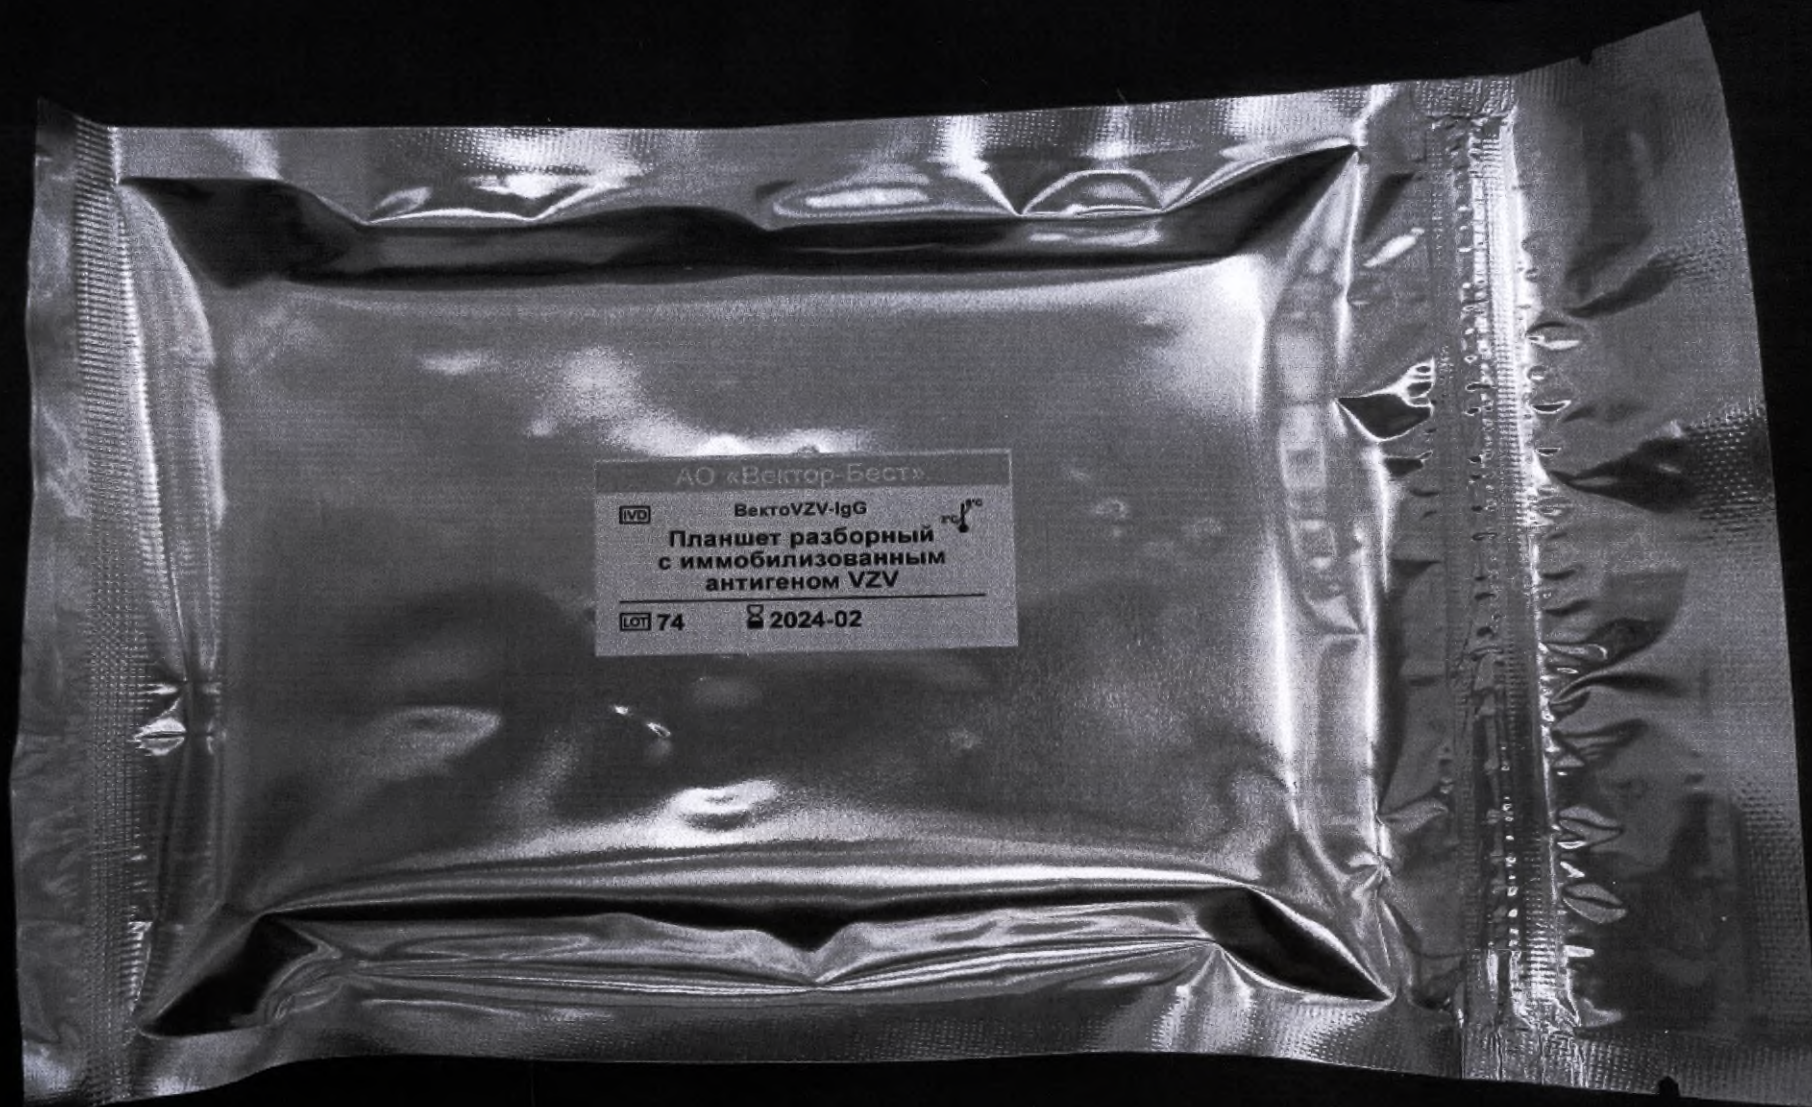


Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
«Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу Варицелла-Зостер (IgG к VZV) в сыворотке (плазме) крови (ВектоVZV-IgG) по ТУ 9398-406-23548172-2013» №2

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

Хусаинов М.Д.

2022 г.

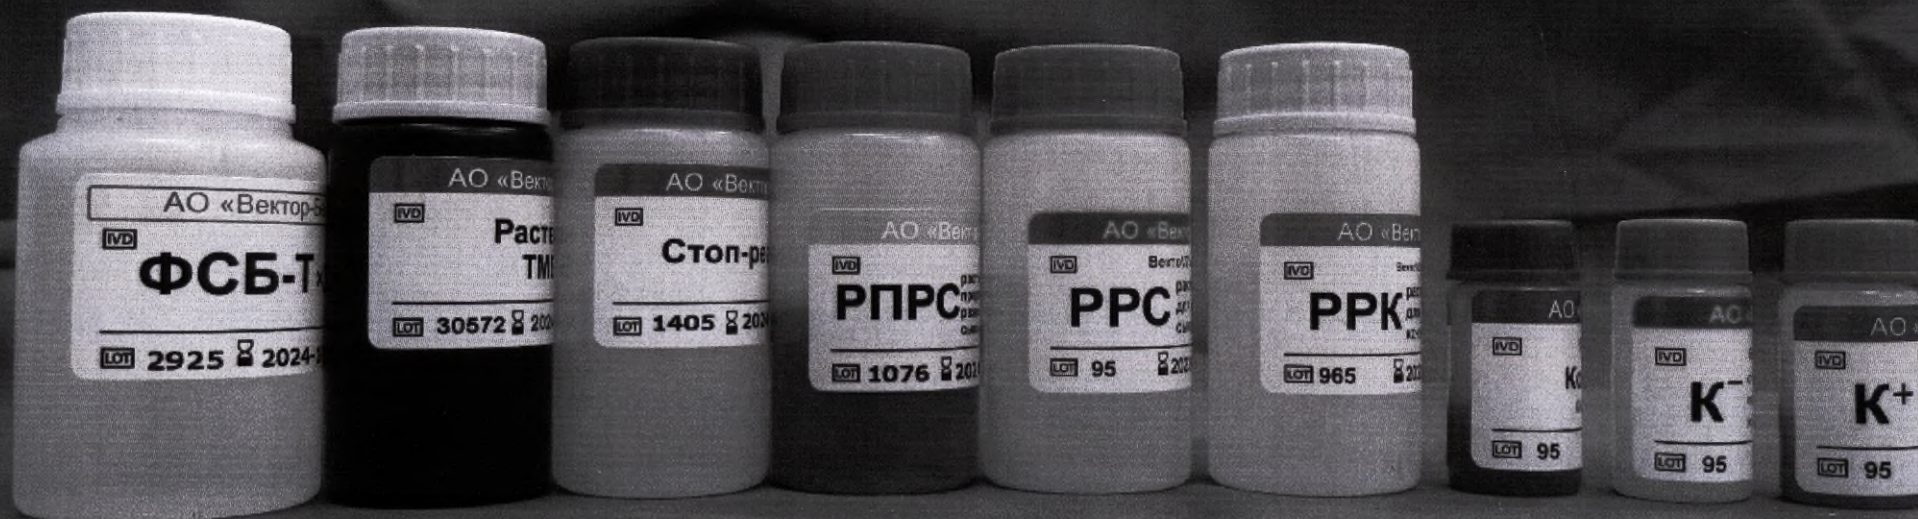


Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия

«Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу Варицелла-Зостер (IgG к VZV) в сыворотке (плазме) крови (ВектоVZV-IgG) по ТУ 9398-406-23548172-2013» №3

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

Хусаинов М.Д.

2022 г.

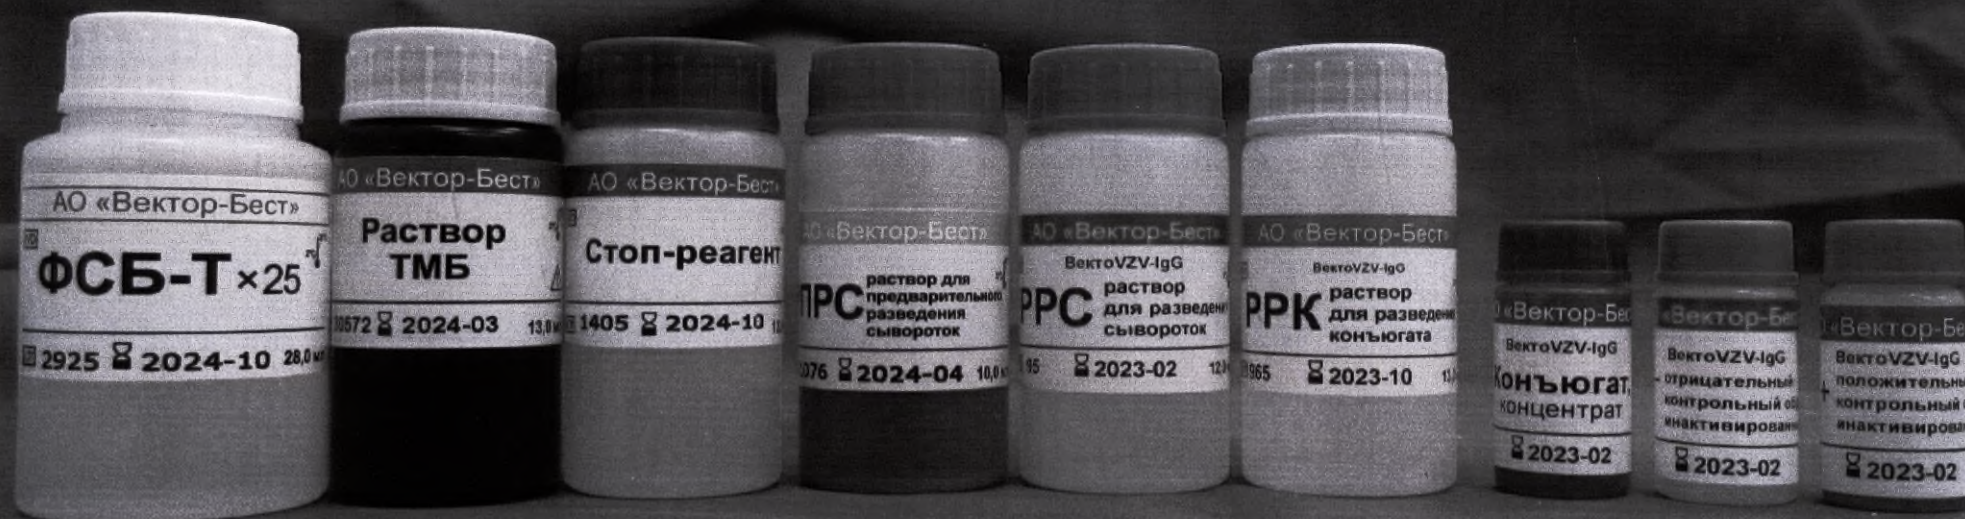

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия

«Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу Варицелла-Зостер (IgG к VZV) в сыворотке (плазме) крови (ВектоVZV-IgG) по ТУ 9398-406-23548172-2013» №4

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

Хусаинов М.Д.

2022 г.

