

Фотографические материалы медицинского изделия
Аппарат обработки интраоральных изображений EzSensor в
исполнениях

Аппарат обработки интраоральных изображений EzSensor Classic, модель IOS-U10IB, модель IOS-U15IB, модель IOS-U20IB



Датчик цифровой IOS-U10IB, IOS-U15IB, IOS-U20IB;

Quick Guide

EzSensor Classic & HD

IOS-U20IF, IOS-U15IF, IOS-U10IF, IOS-U20IB, IOS-U15IB, IOS-U10IB

Руководство по эксплуатации;




USB-накопитель с программным обеспечением EzDent-i, драйверами для работы с сенсорным модулем, данными для калибровки и руководством по эксплуатации




Кабель - переходник USB


🛡️ ООО ЦИРМИ 📧 info@cirmi.ru 🌐 www.goszdravnadzor.ru

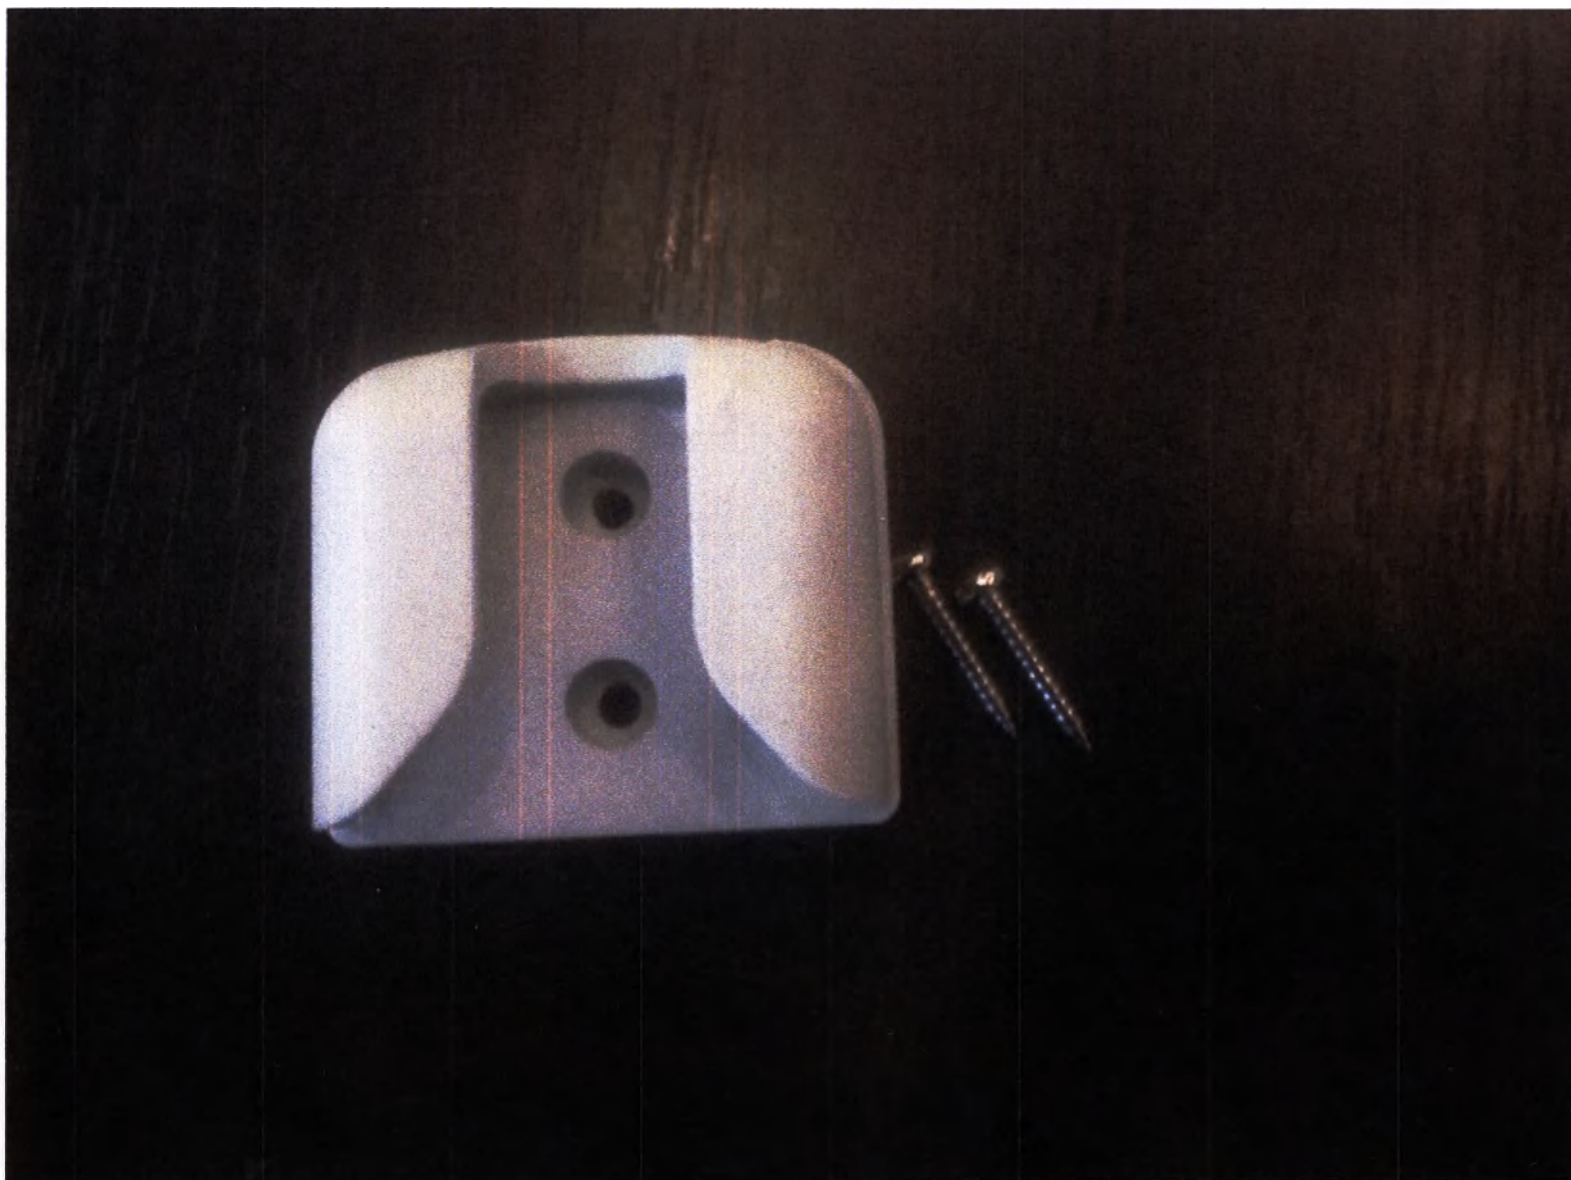

Держатель датчика

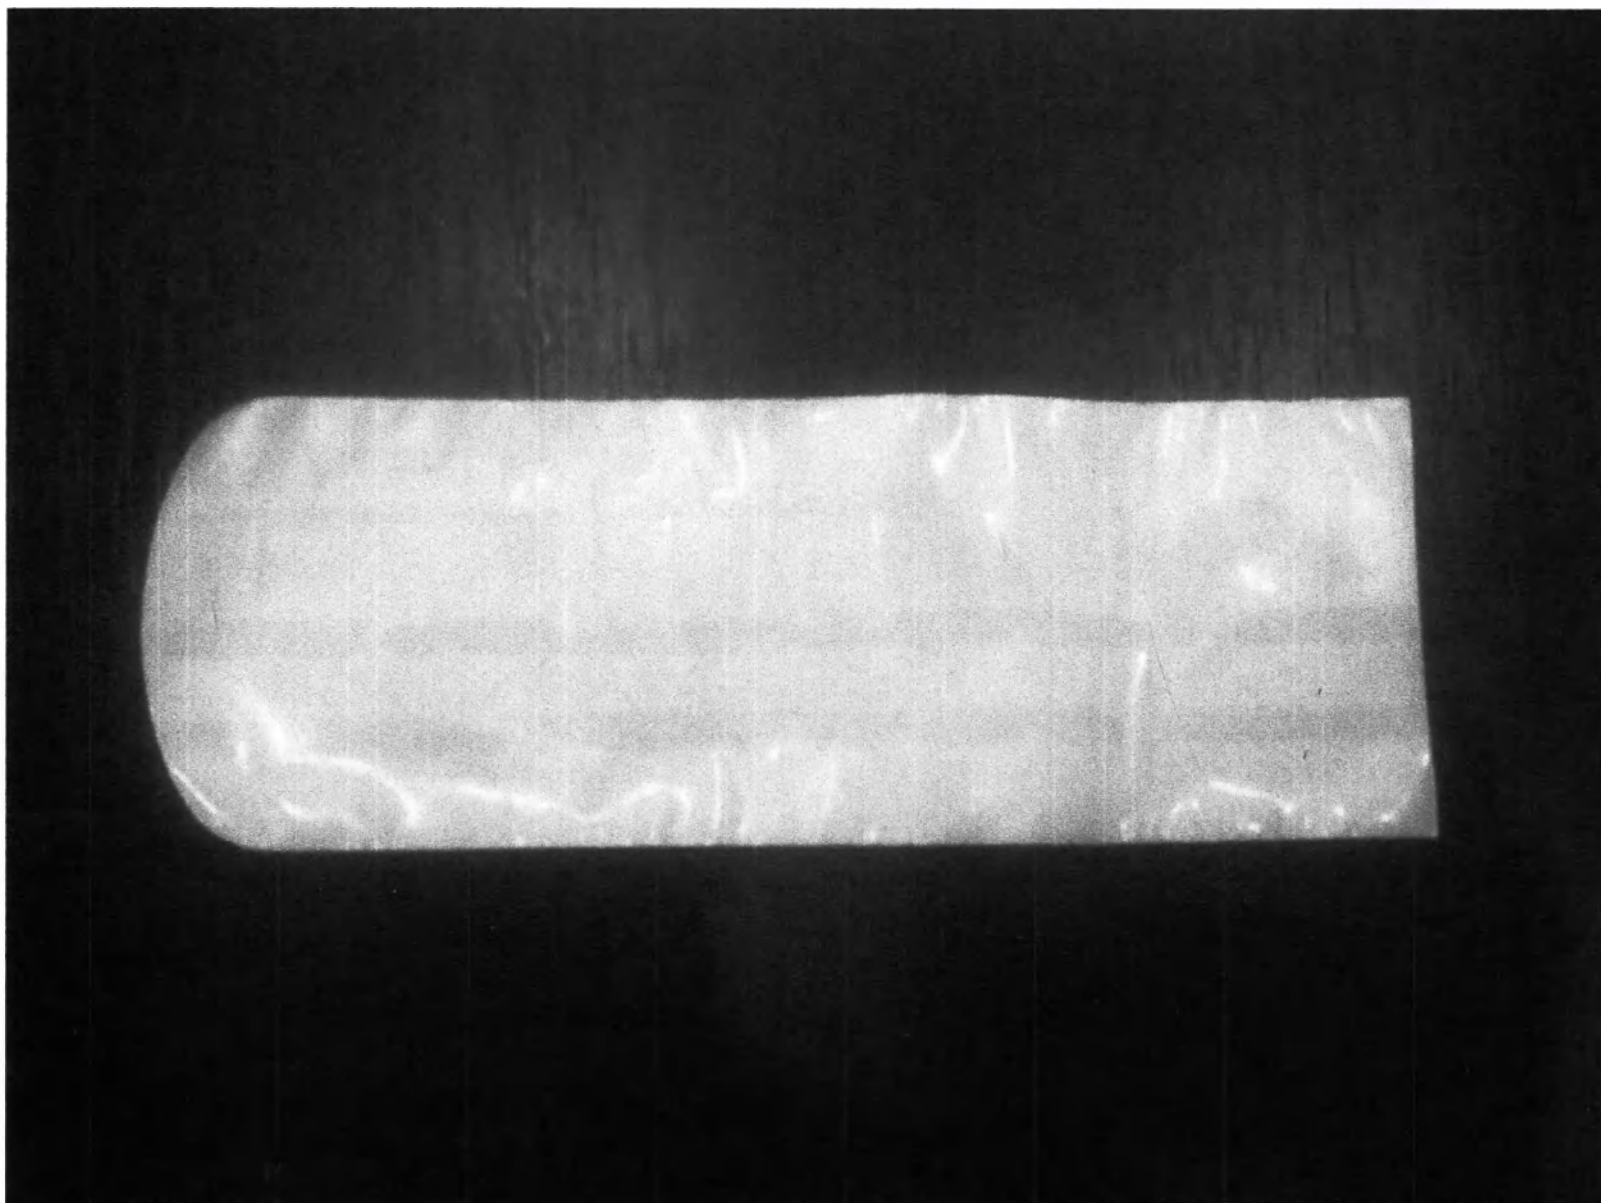


Чехлы одноразовые нестерильные для датчика 1.0, 1.5, 2.0.

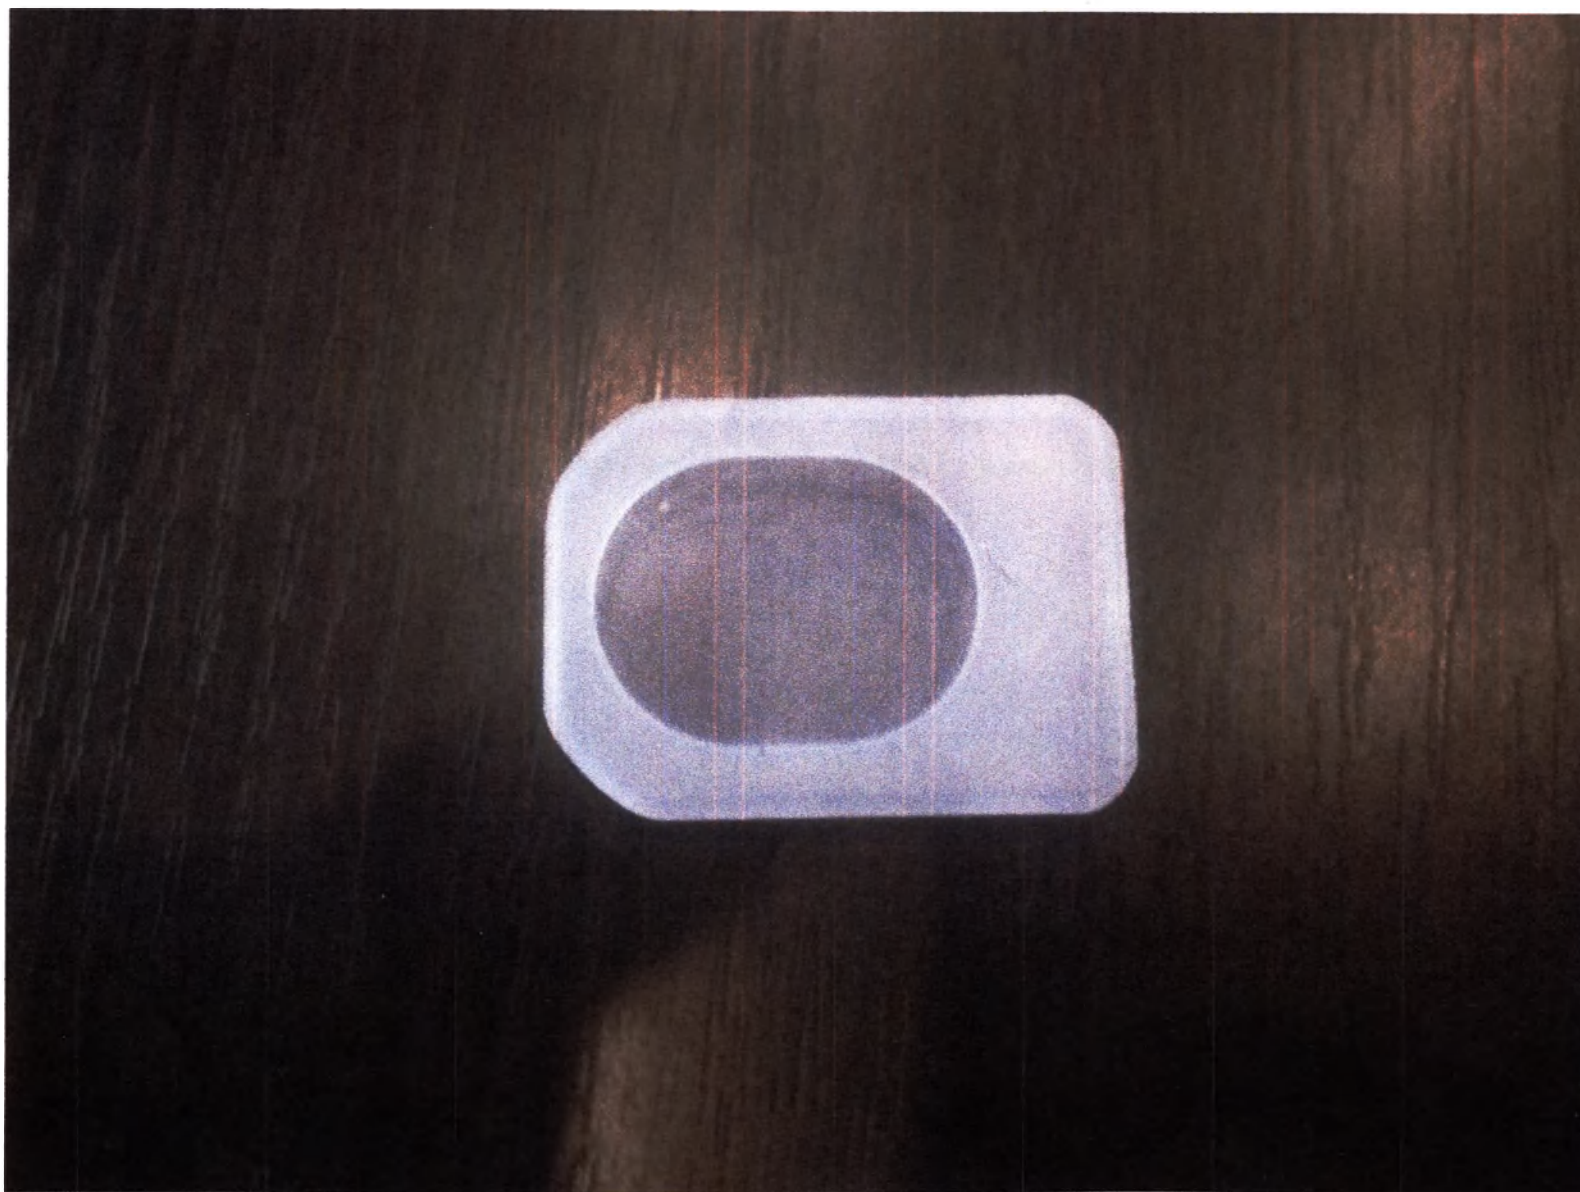

Чехлы силиконовые для датчика 1.0, 1.5, 2.0

Аппарат обработки интраоральных изображений EzSensor HD, модель IOS-U10IF

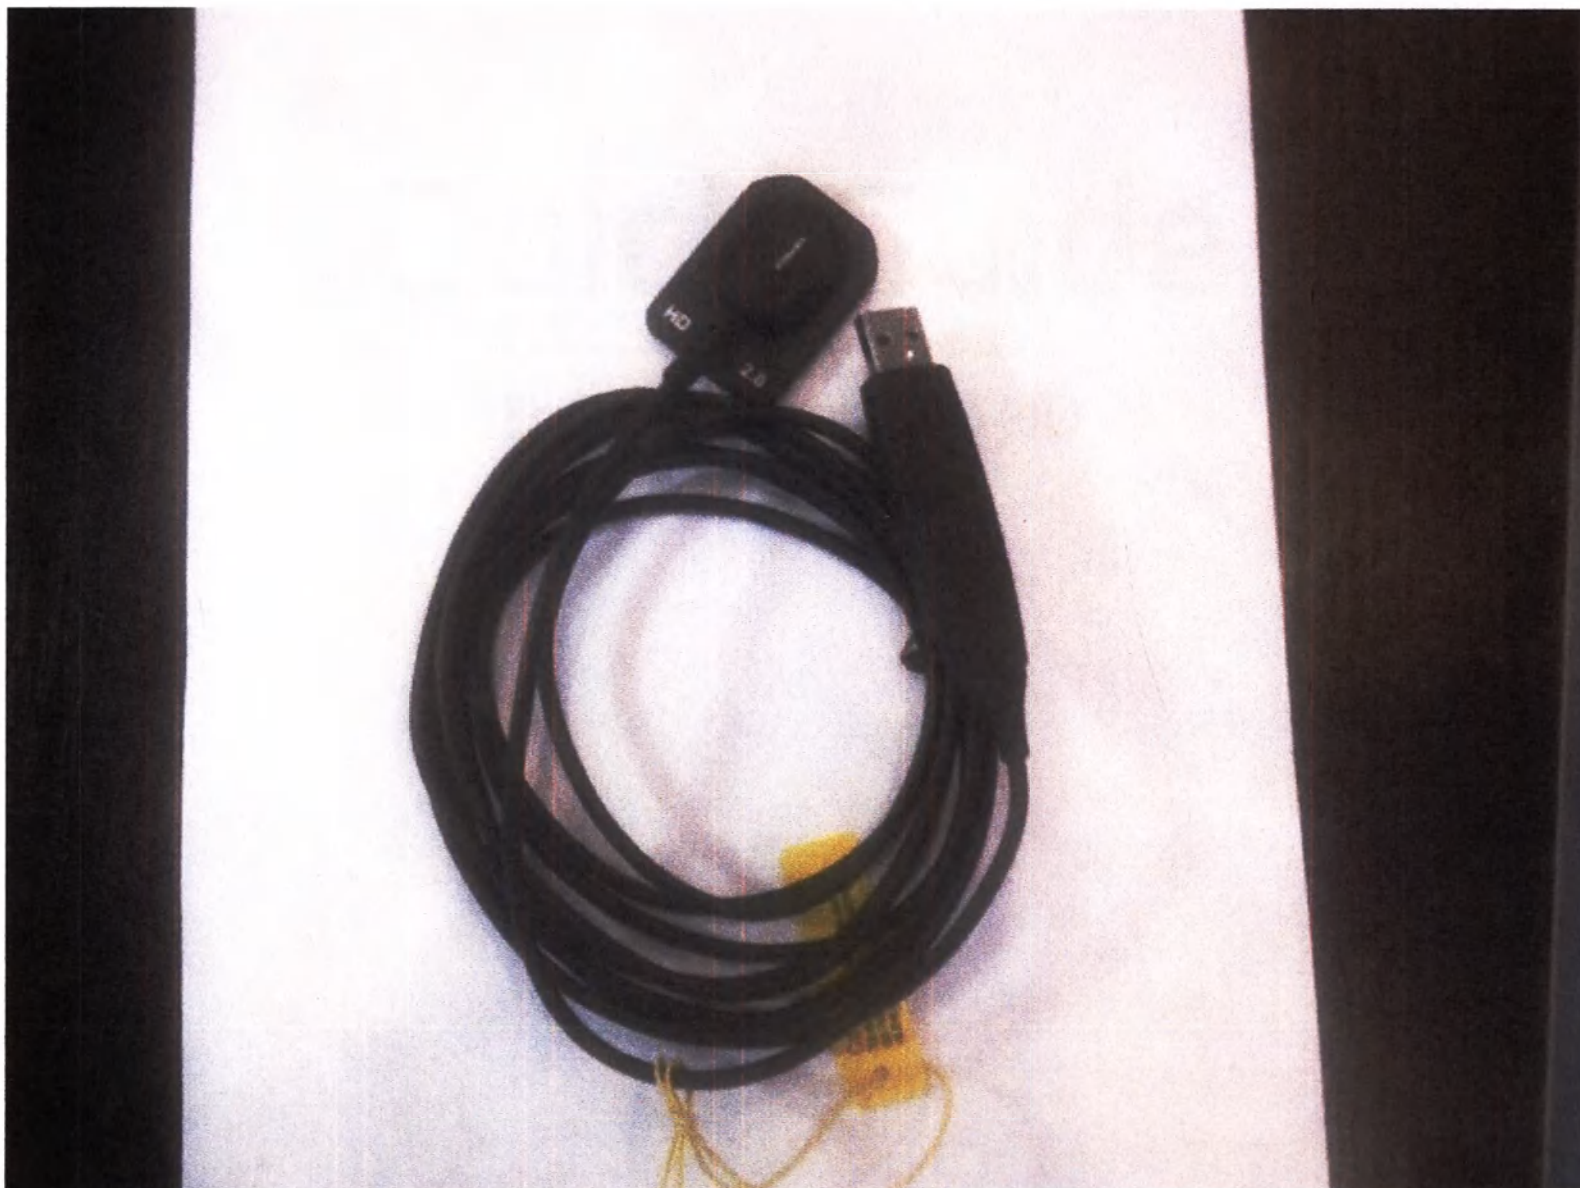

Датчик цифровой IOS-U10IF, IOS-U15IF, IOS-U20IF;

Quick Guide

EzSensor Classic & HD

IOS-U20IF, IOS-U15IF, IOS-U10IF, IOS-U20IB, IOS-U15IB, IOS-U10IB


Руководство по эксплуатации;




USB-накопитель с программным обеспечением EzDent-i, драйверами для работы с сенсорным модулем, данными для калибровки и руководством по эксплуатации




Кабель - переходник USB

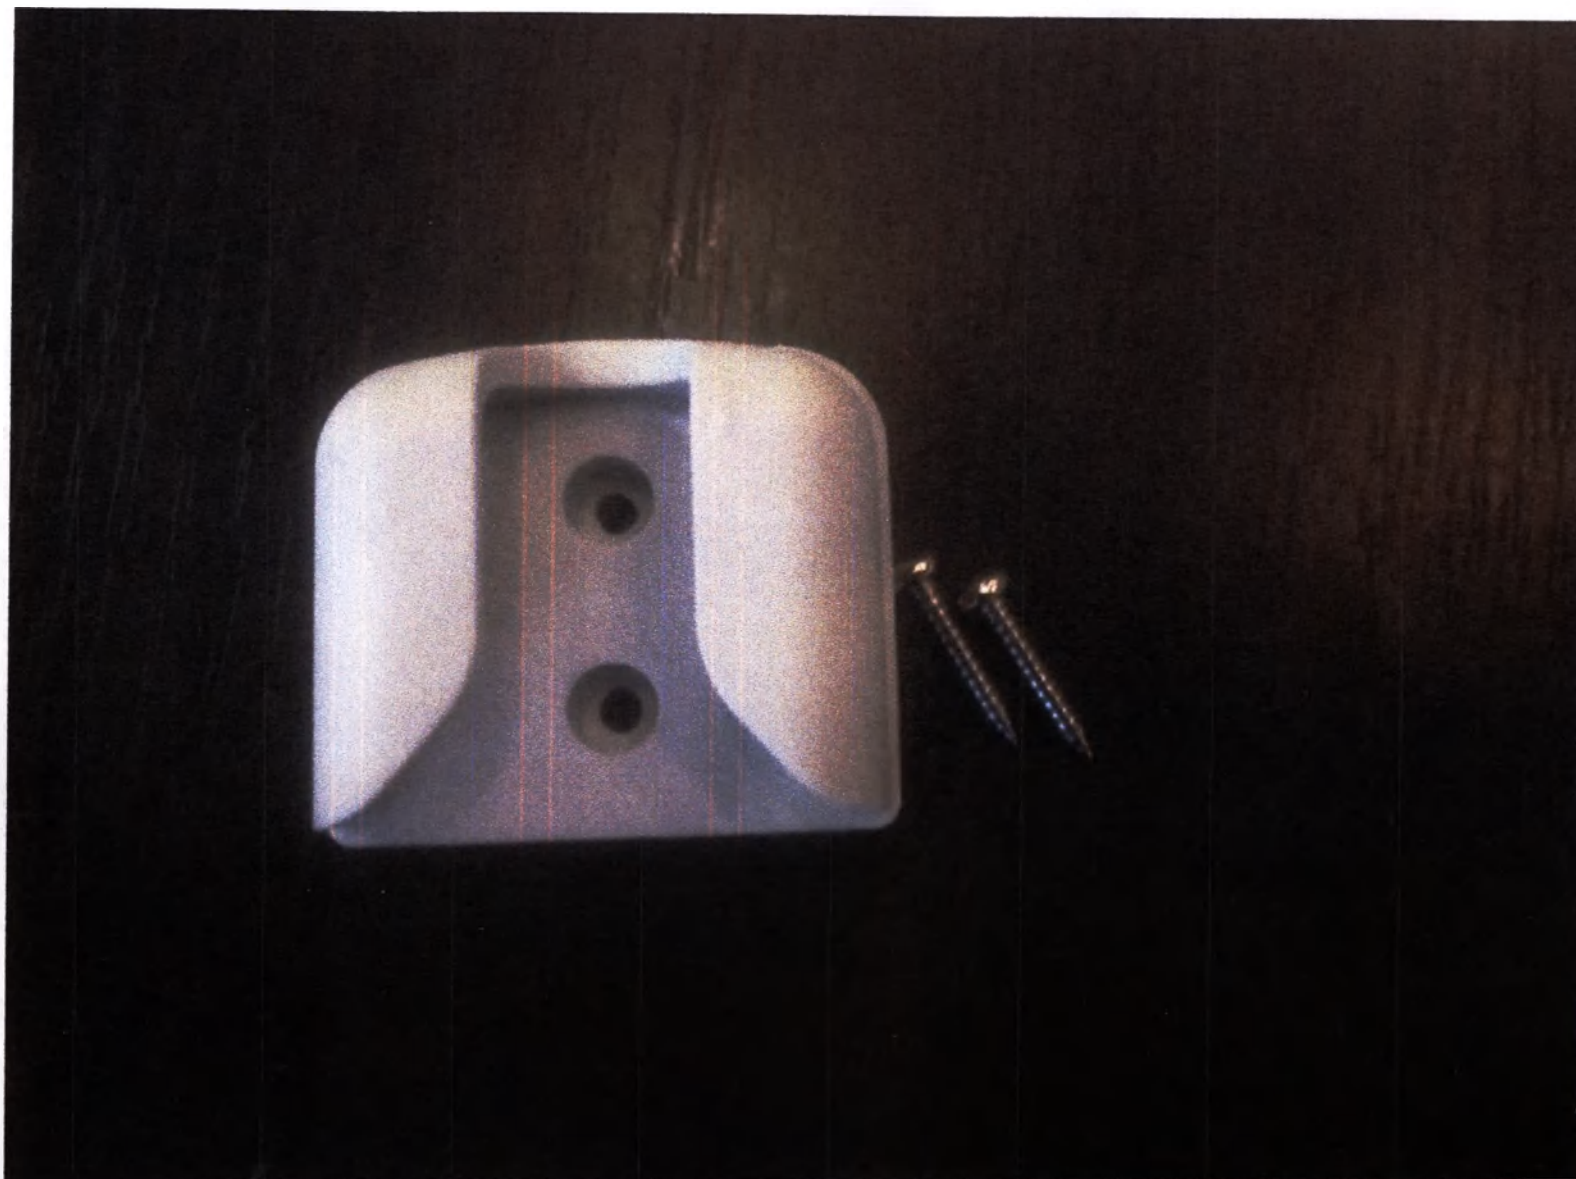

Держатель датчика

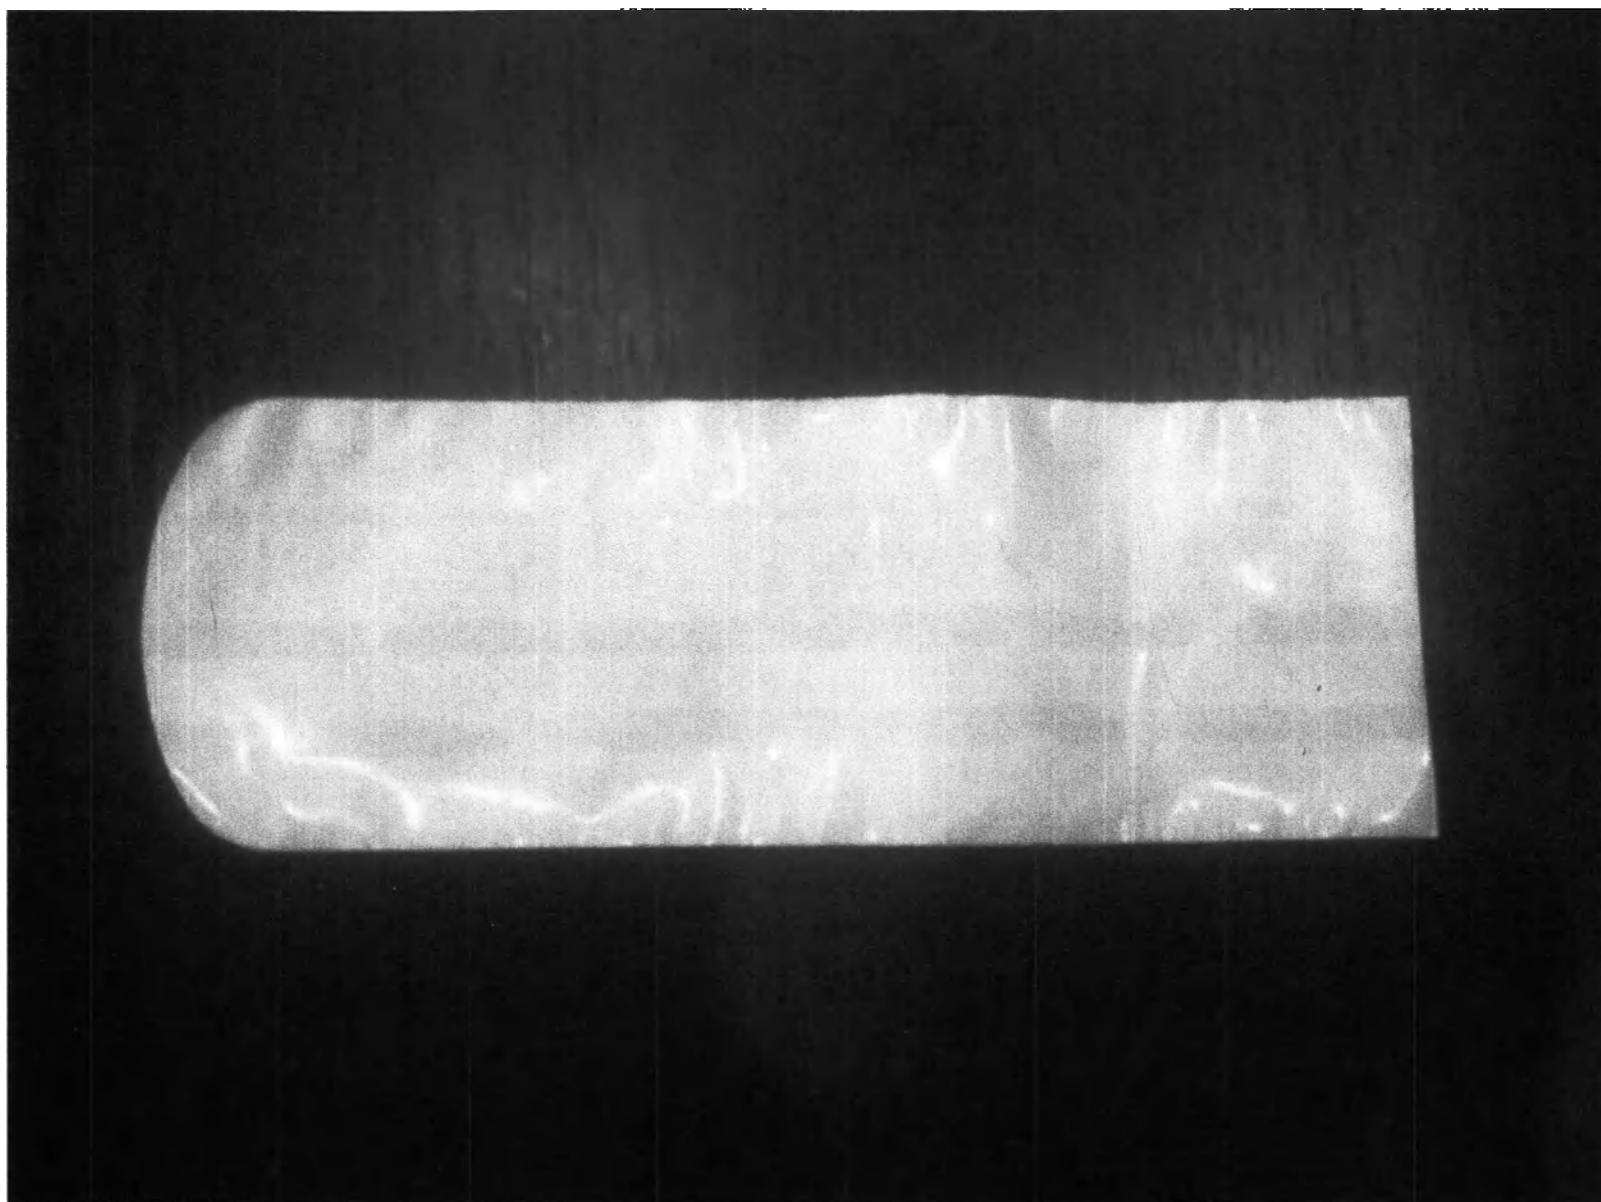

Чехлы одноразовые нестерильные для датчика 1.0, 1.5, 2.0.

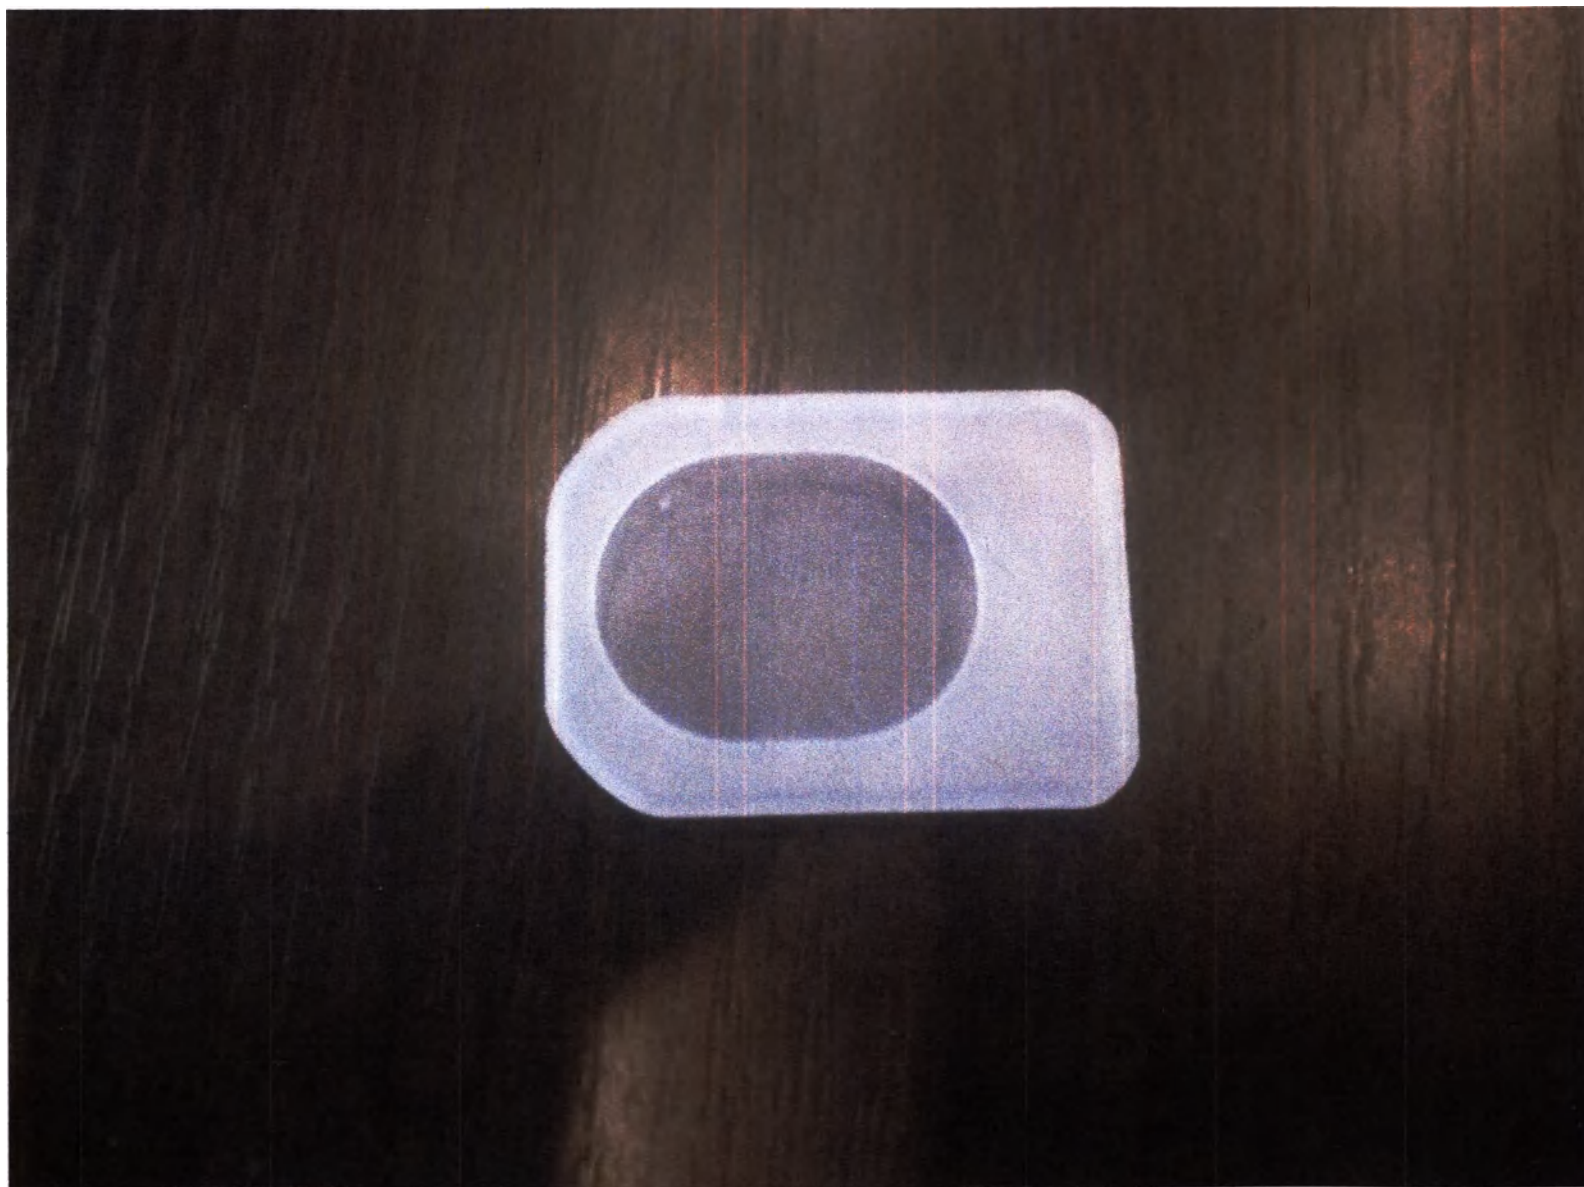

Чехлы силиконовые для датчика 1.0, 1.5, 2.0



Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на 18
листах

