

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «С.П.ГЕЛЛИК»

В.В.Аврамов

«28» 12



**Фотографические изображения
медицинского изделия
«Аппарат стоматологический рентгеновский переносной PORT-X III»**

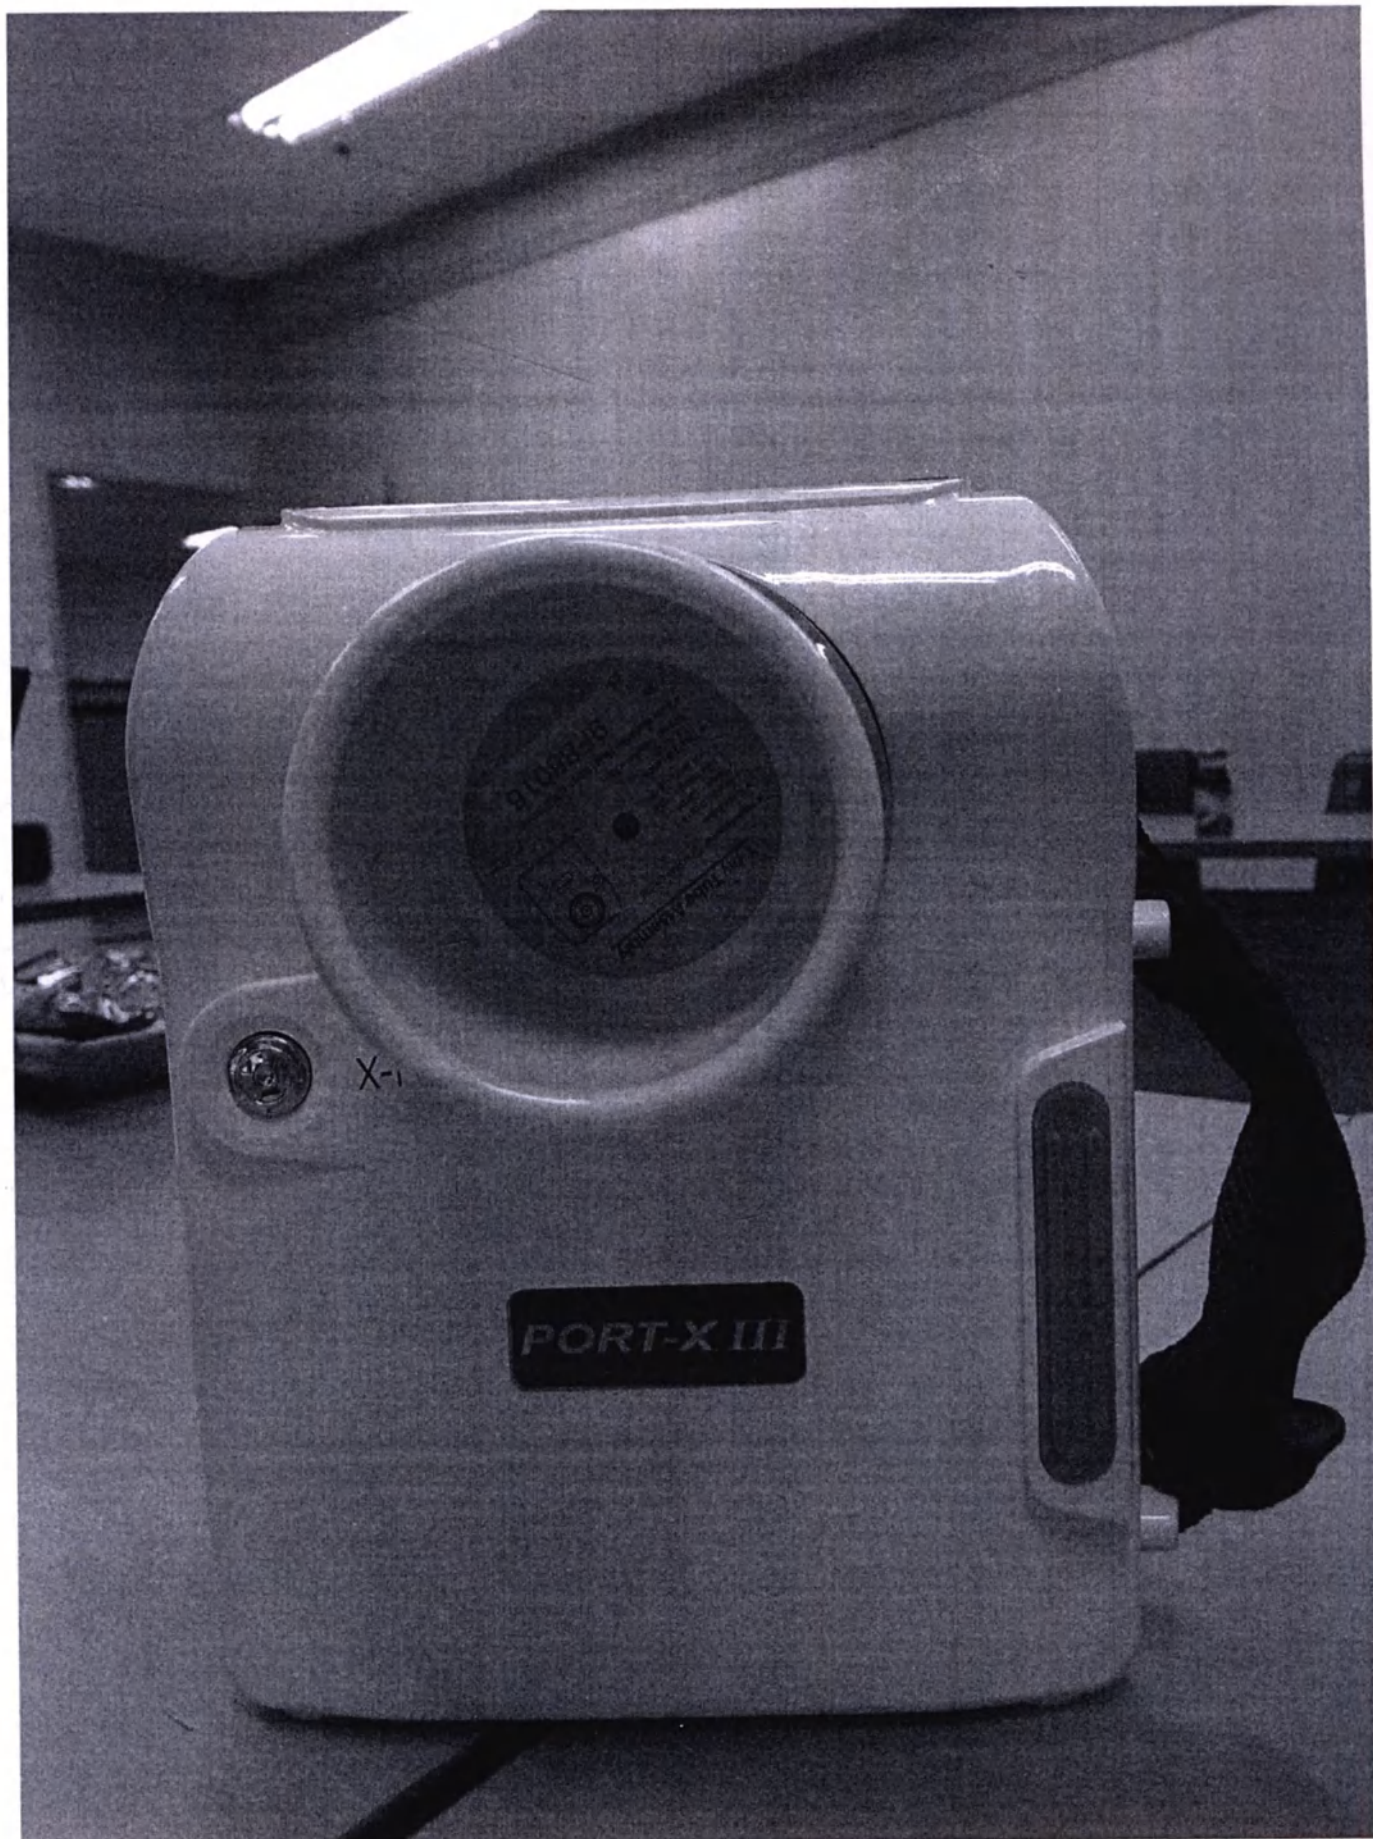


Рис. 1. Аппарат стоматологический рентгеновский переносной PORT-X III

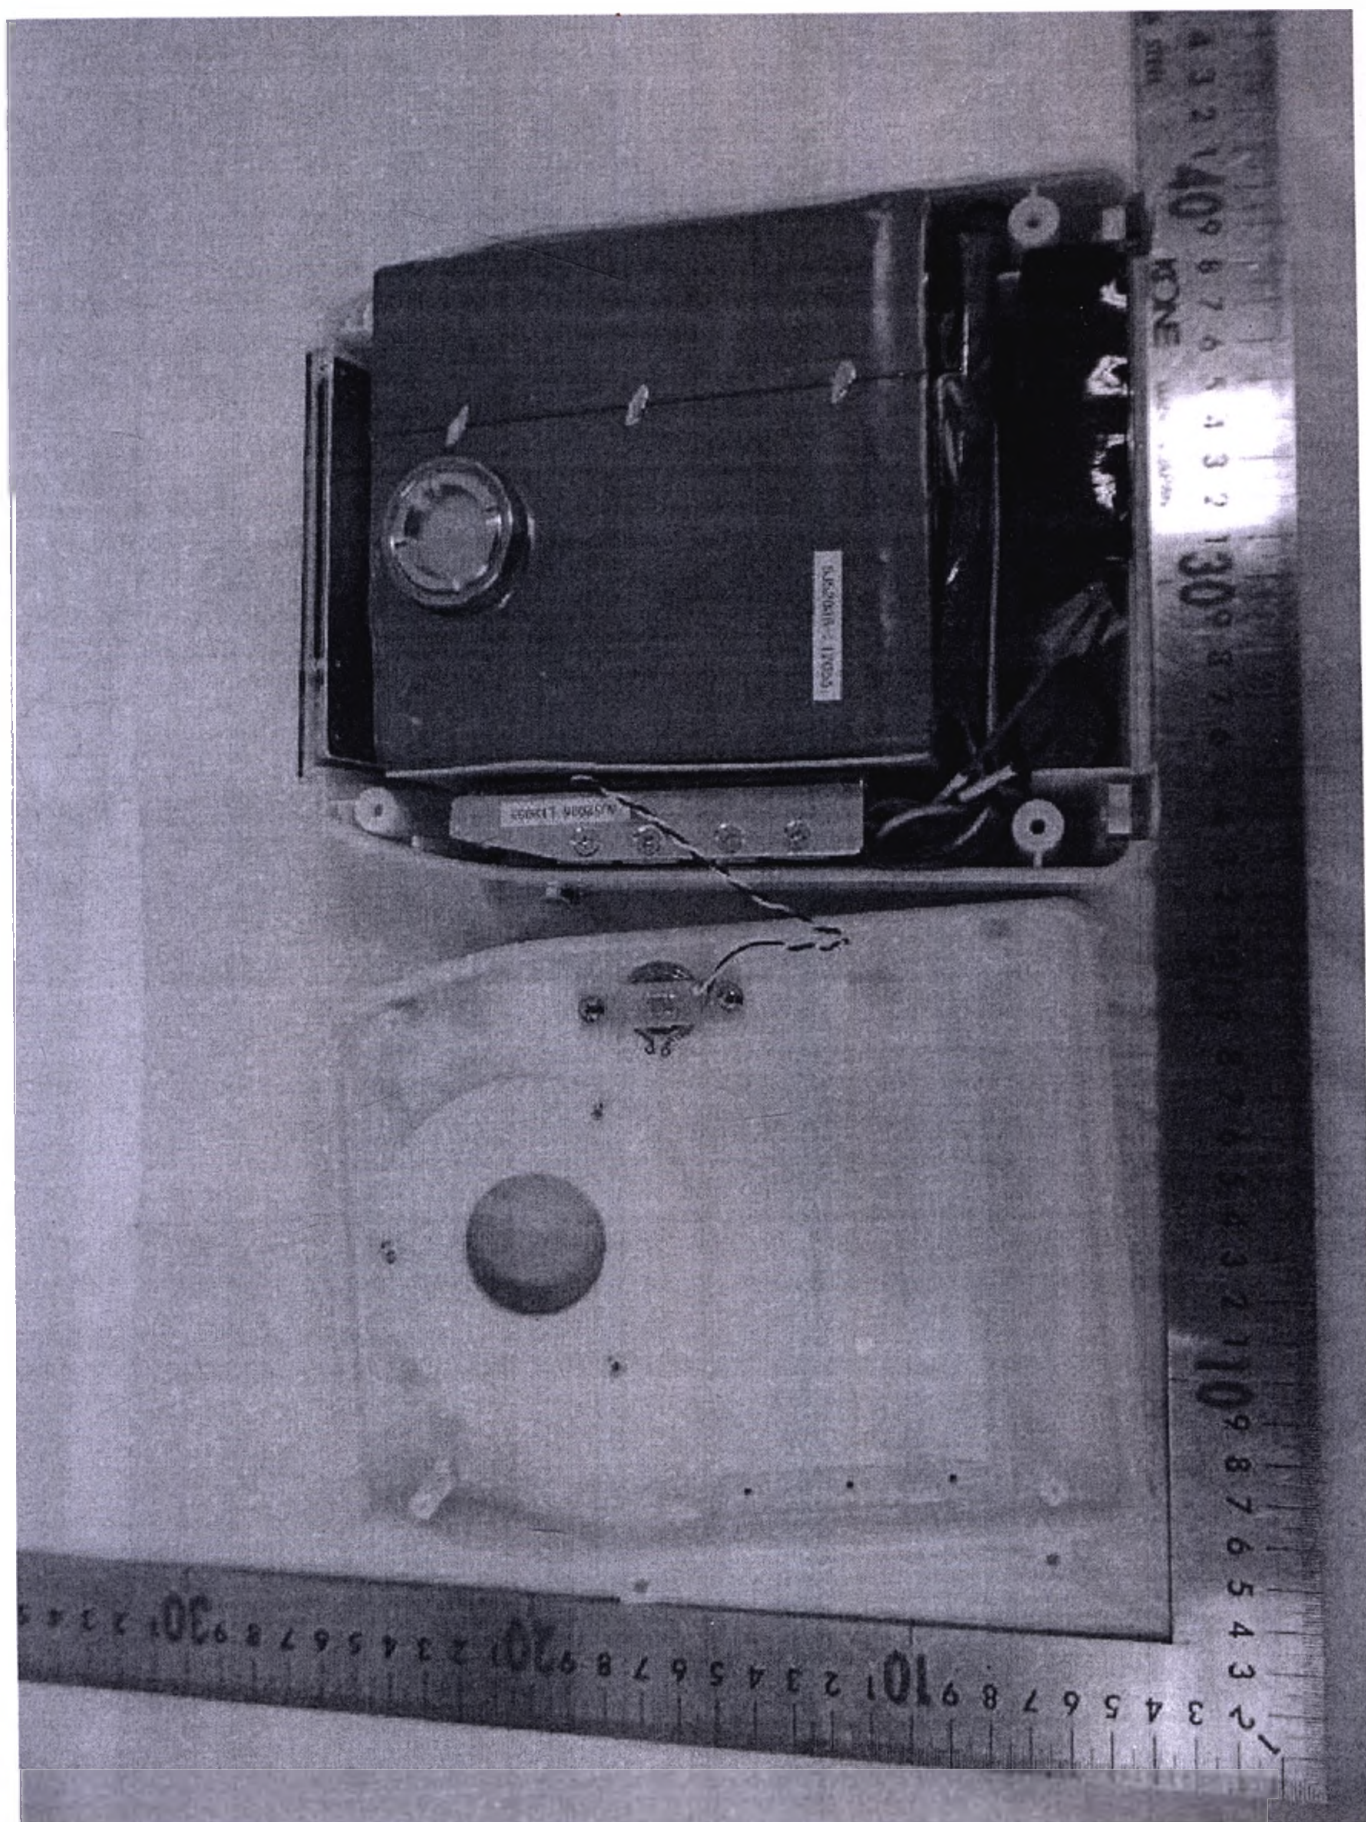


рис.2. Генератор рентгеновского излучения, модель FM02A010 производства Genoray Co., Ltd, Корея

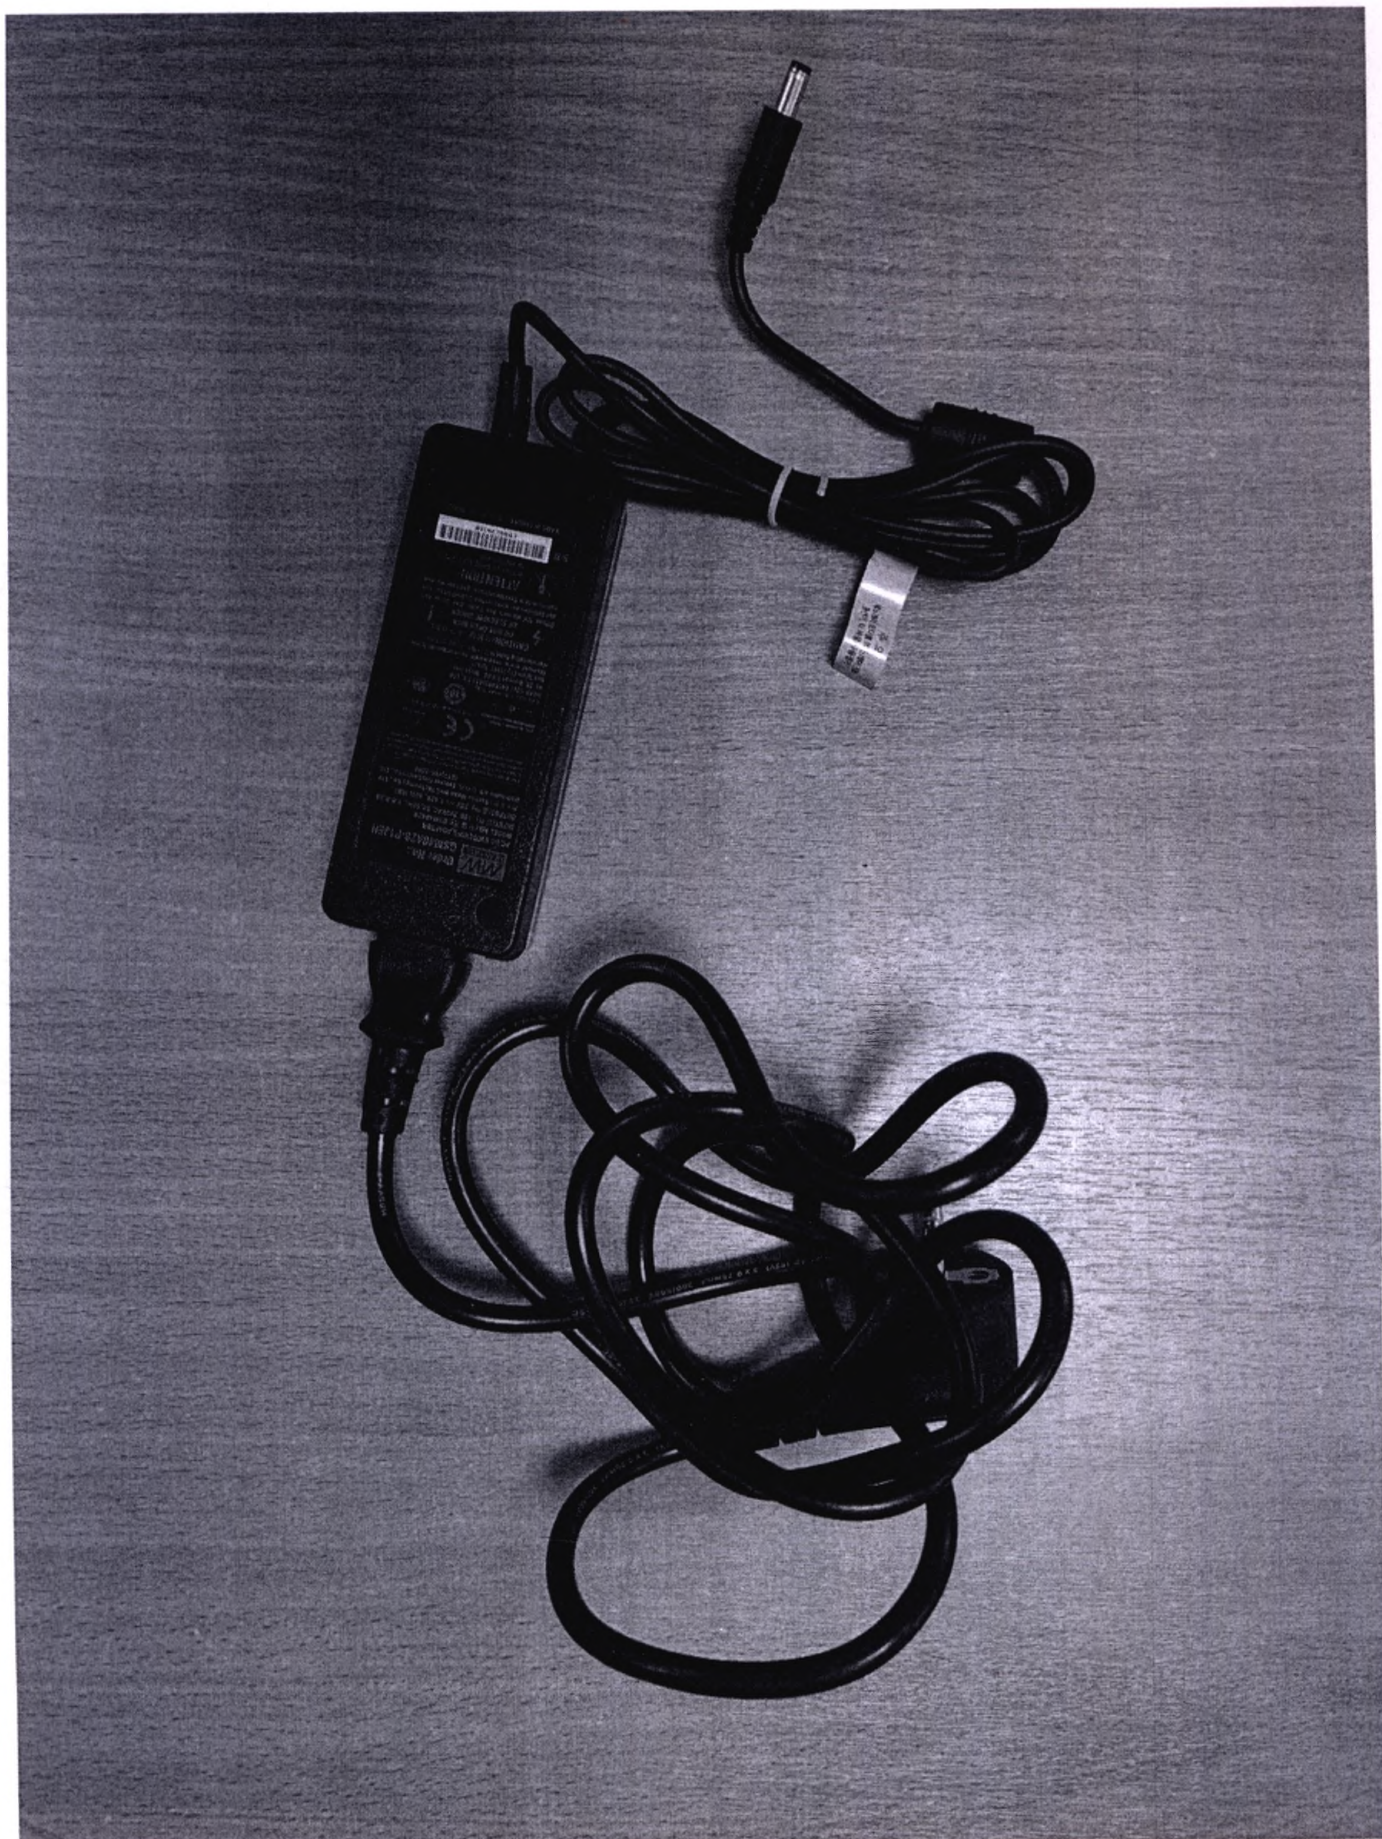


Рис. 3. Зарядное устройство, модель GMS40A28-P1JEN производства Mean Well Enterprises Co.,Ltd., Китай

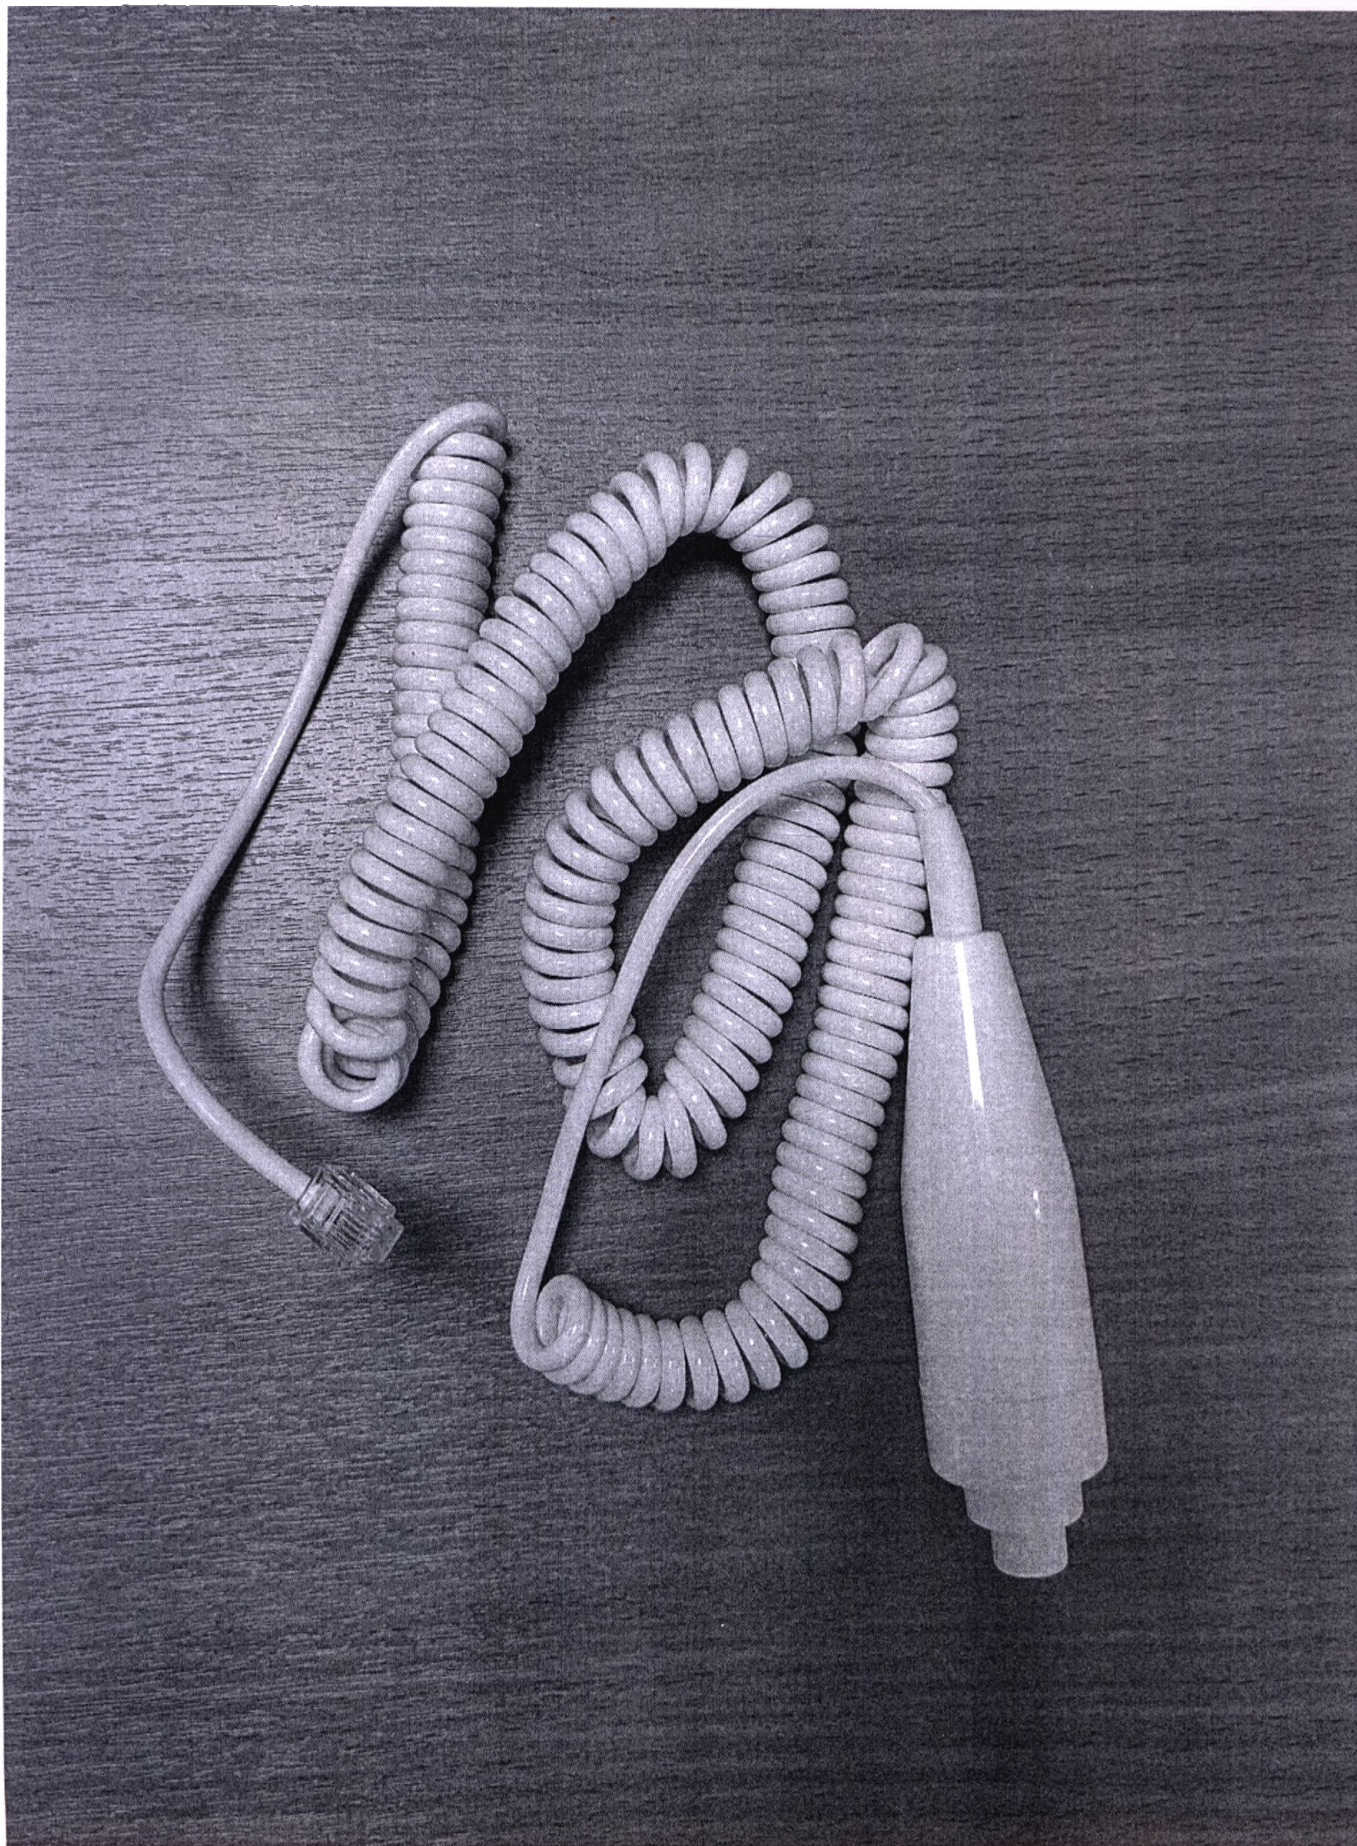


Рис. 4. Выносная кнопка включения экспозиции

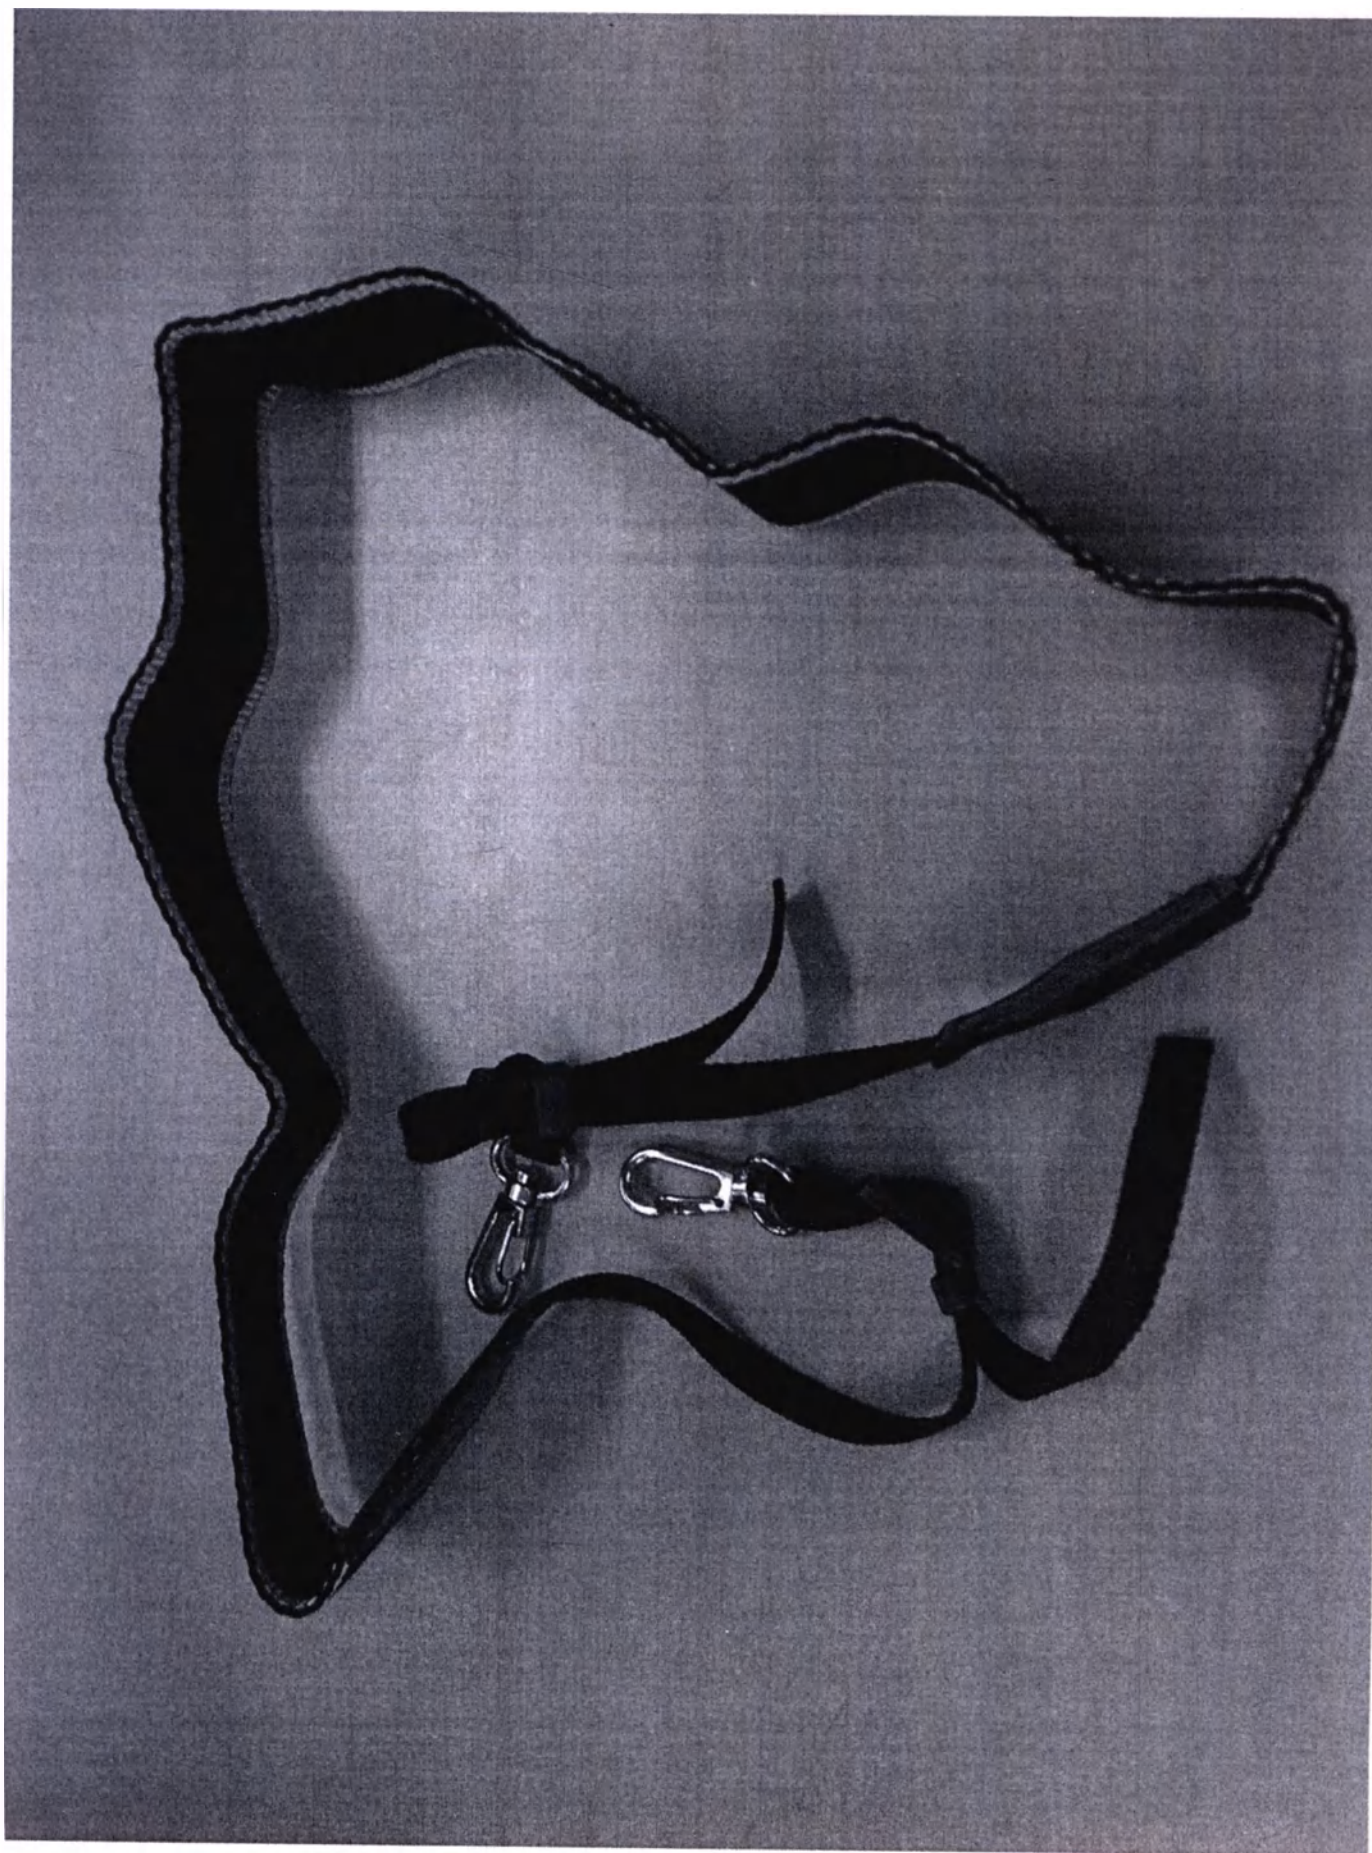


Рис. 5. Плечевой ремень

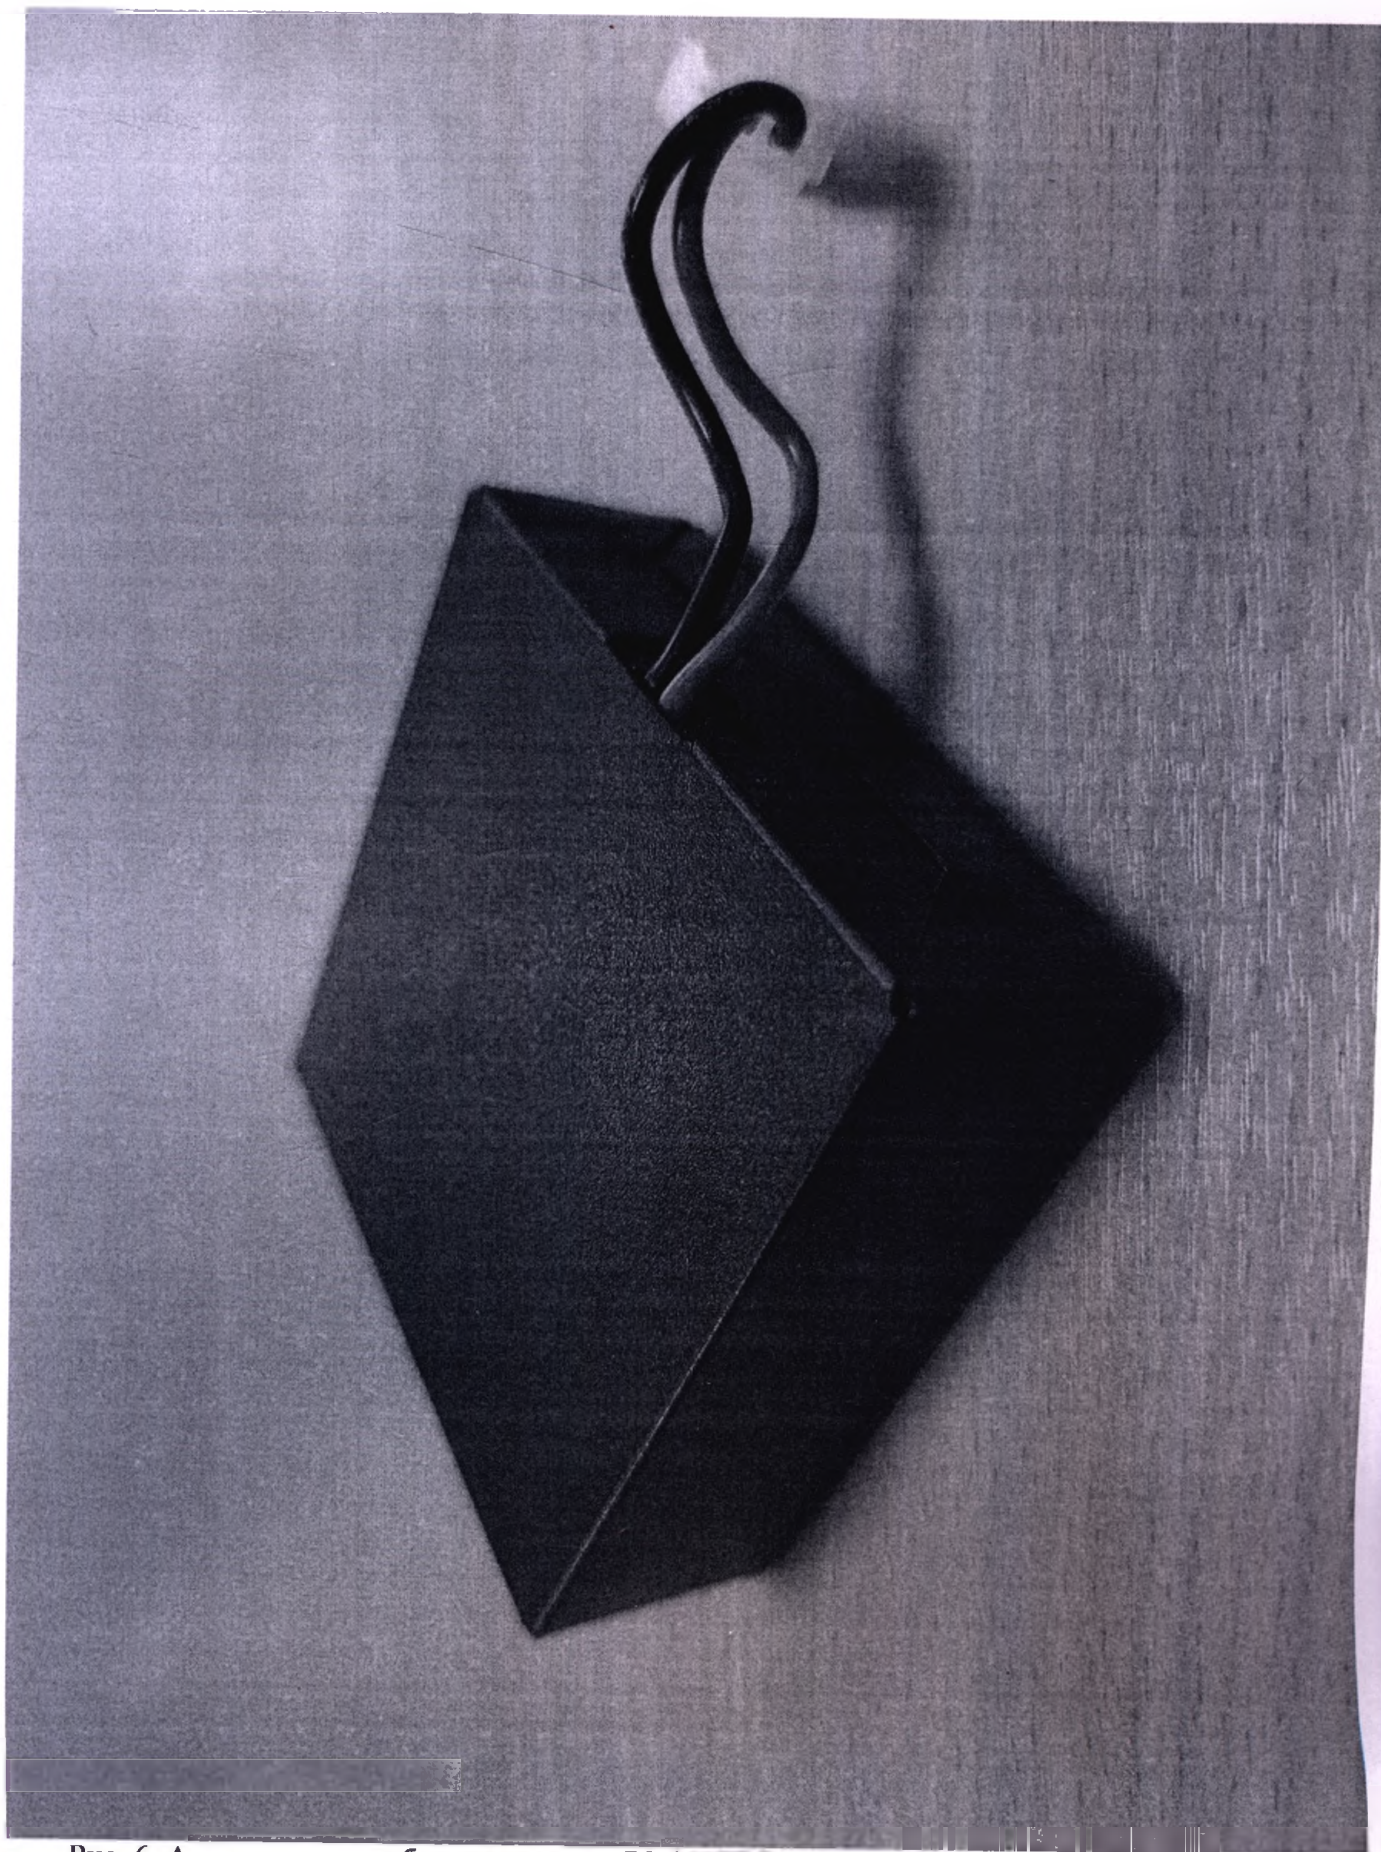


Рис. 6. Аккумуляторная батарея, модель P3-061PFC производства BN TECH Co.,Ltd, Корея



Рис. 7. Штатив, модель NLTRL14/18 производства NUOBI, Китай

■ Product Name : Portable X-ray System

■ Model : PORT-X III

■ X-ray Tube Voltage and Current
: 60kV, 2mA (fixed)

■ Use Only with DC Adaptor 28V $\equiv$ 1.42 A



■ SN :






Follow Instruction for use

■  GENORAY Co., Ltd. (KOREA)

Address: 512, Byucksan Technopia, 560, Dunchon-daero,
Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea



Authorized Representative

Name : Obelis s.a.



Address : Boulevard Général Wahnis 53, 1030 Brussels, BELGIUM

Tel : +(32) 2 7325854 Fax : +(32) 2 7328003 E-Mail : mail@obelis.net

Focal Spot Size : 0,8 mm

A : 200 $\pm$ 1mm

B : 77,5 $\pm$ 1mm

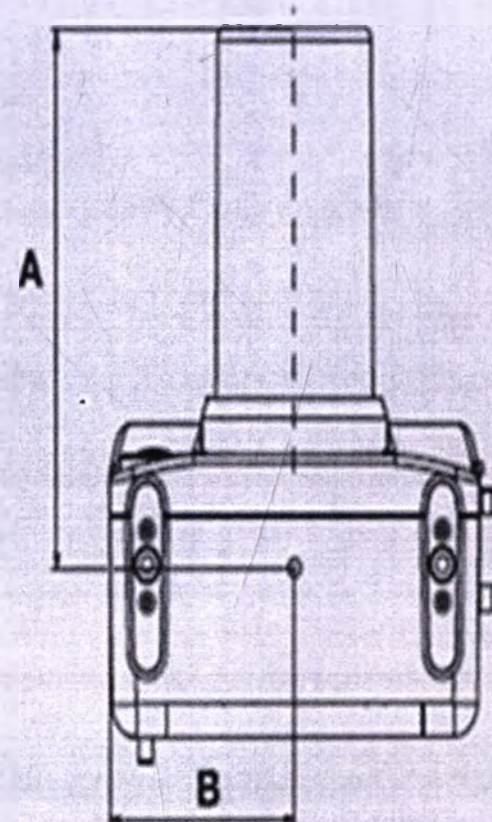

CAUTION
X-RAY
RADIATION



X-RAY
RADIATION
INSIDE





Рис. 9. Упаковка медицинского изделия

в данном документе
пронумеровано,
прошнуровано и скреплено
печатью всего 10 листов

Генеральный директор
ООО "С.П. ЕЛПИК"
Аврамцов В.В.

