

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «ИМБИАН ЛАБ»



**Набор реагентов для качественного выявления методом ПЦР in vitro ДНК
возбудителей инфекций *Mycoplasma hominis*, *Mycoplasma genitalium* в препаратах
нуклеиновых кислот, полученных из клинических образцов в режиме реального
времени «Мико-Н/Г-ИМБИАН-ПЦР» по ТУ 21.20.23-119-41390295-2021**

Макет маркировки

Комплект 1


Мико-Н/Г- ИМБИАН-ПЦР



ООО «ИМБИАН ЛАБ»

**ПЦР-смесь-Mg/Mh, 10 мкл-
14 стрипов по 8 ПЦР-пробирок**
(Маркировать не заходя на
прозрачную область для
считывания флуоресценции)

LOT XXXXXX ГГГГ-ММ-ДД




Мико-Н/Г-ИМБИАН-ПЦР

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Тaq-ДНК-полимераза - 1120 мкл

ГГГГ-ММ-ДД LOT XXXXXX



Мико-Н/Г-ИМБИАН-ПЦР

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

ПКО - 250 мкл

REF XX-XXX/X
ГГГГ-ММ-ДД LOT XXXXXX




Мико-Н/Г-ИМБИАН-ПЦР

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

ВКО - 1120 мкл

ГГГГ-ММ-ДД LOT XXXXXX




Мико-Н/Г-ИМБИАН-ПЦР

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

ОКО - 1500 мкл

ГГГГ-ММ-ДД LOT XXXXXX



Мико-Н/Г- ИМБИАН-ПЦР

Набор реагентов для количественного выявления методом ПЦР
in vitro ДНК возбудителей инфекций *Mycoplasma genitalium* в
препаратах нуклеиновых кислот, полученных их клинических
образцов в режиме реального времени «Мико-Н/Г-ИМБИАН-ПЦР»
по ТУ 21.20.23-119-41390295-2021

Imbian

Комплект 1


- 1 Реакционная смесь Mg/Mh (ПЦР-смесь-Mg/Mh), 10 мкл
- 2 Таq-ДНК-полимераза, 1120 мкл
- 3 Положительный контрольный образец (ПКО), 250 мкл
- 4 Внутренний контрольный образец (ВКО), 1120 мкл
- 5 Отрицательный контрольный образец (ОКО), 1500 мкл
- 6 Вкладыш с данными контрольных образцов
- 7 Инструкция

Замораживать не допускается.
Только для in vitro диагностики.
ТУ 21.20.23-119-41390295-2021
Для профессионального применения

- 14 стрипов по
8 ПЦР-пробирок
- 1 пробирка
- 1 пробирка
- 2 пробирки
- 1 пробирка
- 1 шт
- 1 шт

РУ № XXX XXXX/XXXXX

LOT XXXXXX
REF XX-XXX/X
ГГГГ-ММ-ДД
ГГГГ-ММ-ДД



ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Новосибирская обл.,
Г.О. Рабочий поселок Кольцово,
РП Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7,
этаж 2, помещ. 2
8-800-600-90-77, info@imbian.ru

Комплект 2

Мико-Н/Г-ИМБИАН-ПЦР 
ООО «ИМБИАН ЛАБ»

ПЦР-смесь-Mg/Mh, 10 мкл-112 отдельных ПЦР-пробирок

LOT XXXXXX ГГГГ-ММ-ДД

  +2°C  +8°C IVD 

Мико-Н/Г-ИМБИАН-ПЦР 
ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Тақ-ДНК-полимераза - 1120 мкл

ГГГГ-ММ-ДД LOT XXXXXX  +2°C  +8°C IVD

Мико-Н/Г-ИМБИАН-ПЦР 
ООО «ИМБИАН ЛАБ»

ПКО - 250 мкл

REF XX-XXX/X ГГГГ-ММ-ДД LOT XXXXXX  +2°C  +8°C IVD

Мико-Н/Г-ИМБИАН-ПЦР 
ООО «ИМБИАН ЛАБ»

ВКО - 1120 мкл

ГГГГ-ММ-ДД LOT XXXXXX  +2°C  +8°C IVD

Мико-Н/Г-ИМБИАН-ПЦР 
ООО «ИМБИАН ЛАБ»

ОКО - 1500 мкл

ГГГГ-ММ-ДД LOT XXXXXX  +2°C  +8°C IVD

Мико-Н/Г-ИМБИАН-ПЦР

Комплект 2

- 1 Реакционная смесь Mg/Mh (ПЦР-смесь-Mg/Mh), 10 мкл
- 2 Тақ-ДНК-полимераза, 1120 мкл
- 3 Положительный контрольный образец (ПКО), 250 мкл
- 4 Внутренний контрольный образец (ВКО), 1120 мкл
- 5 Отрицательный контрольный образец (ОКО), 1500 мкл
- 6 Вкладыш с данными контрольных образцов
- 7 Инструкция

Замораживать не допускается
Только для in vitro диагностики.
ТУ 21.20.23-119-41390295-2021
Для профессионального применения

Набор реагентов для количественного выявления методом ПЦР in vitro ДНК возбудителей инфекций Mycoplasma genitalium в препаратах нуклеиновых кислот, полученных их клинических образцов в режиме реального времени «Мико-Н/Г-ИМБИАН-ПЦР» по ТУ 21.20.23-119-41390295-2021



112 отдельных ПЦР пробирок
1 пробирка
1 пробирка
2 пробирки
1 пробирка
1 шт
1 шт

ПУ № XXX XXXX/XXXXX

LOT XXXXXX
REF XX-XXX/X
ГГГГ-ММ-ДД
ГГГГ-ММ-ДД

ИВД  112 +2°C  +8°C  

ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Новосибирская обл.,
Г.О. Рабочий поселок Колыцово,
РП Колыцово, ул. Садовая, д. 2/7,
этаж 2, помещ. 2
8-800-600-90-77; info@imbian.ru

Мико-Н/Г- ИМБИАН-ПЦР

Набор реагентов для качественного выявления методом ПЦР in vitro ДНК возбудителей инфекций *Mycoplasma hominis*, *Mycoplasma genitalium* в препаратах нуклеиновых кислот, полученных из клинических образцов в режиме реального времени «Мико-Н/Г-ИМБИАН-ПЦР» по ТУ 21.20.23-119-41390295-2021

РУ № XXX XXXX/XXXXX
ТУ 21.20.23-119-41390295-2021

Комплект 1/Комплект 2 -
нужное подчеркнуть

Количество
наборов

шт

Масса нетто

кг

Масса брутто

кг

Масса нетто
потребительской
упаковки

кг

LOT XXXXXX

ГГГГ-ММ-ДД

REF XX-XXX/X

ГГГГ-ММ-ДД

+2°C
Замораживать не допускается
Допустима
транспортировка при
температуре от +2 до +8°C



IVD



ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630658, Новосибирская обл.,
Г.О. Рабочий поселок Кольцово,
РП Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7,
этаж 2, помещ. 2
8-800-800-90-77; info@imbian.ru

Генеральный директор ООО «ИМБИАН ЛАБ»



В.В. Осипова

Сшито и заверено печатью 4
(тетрадь) лист а

Генеральный директор ООО «Имбиан лаб»
Осипова В.В.



«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «ИМБИАН ЛАБ»



В.В.Осыпова
«29» 2022 г.

Фотографические изображения общего вида

Набор реагентов для качественного выявления методом ПЦР *in vitro* ДНК возбудителей инфекций *Mycoplasma hominis*, *Mycoplasma genitalium* в препаратах нуклеиновых кислот, полученных из клинических образцов в режиме реального времени «Мико-Н/Г-ИМБИАН-ПЦР» по ТУ 21.20.23-119-41390295-2021

Комплект 1:

Реакционная смесь Mg/Mh (ПЦР-смесь-Mg/Mh), 10 мкл

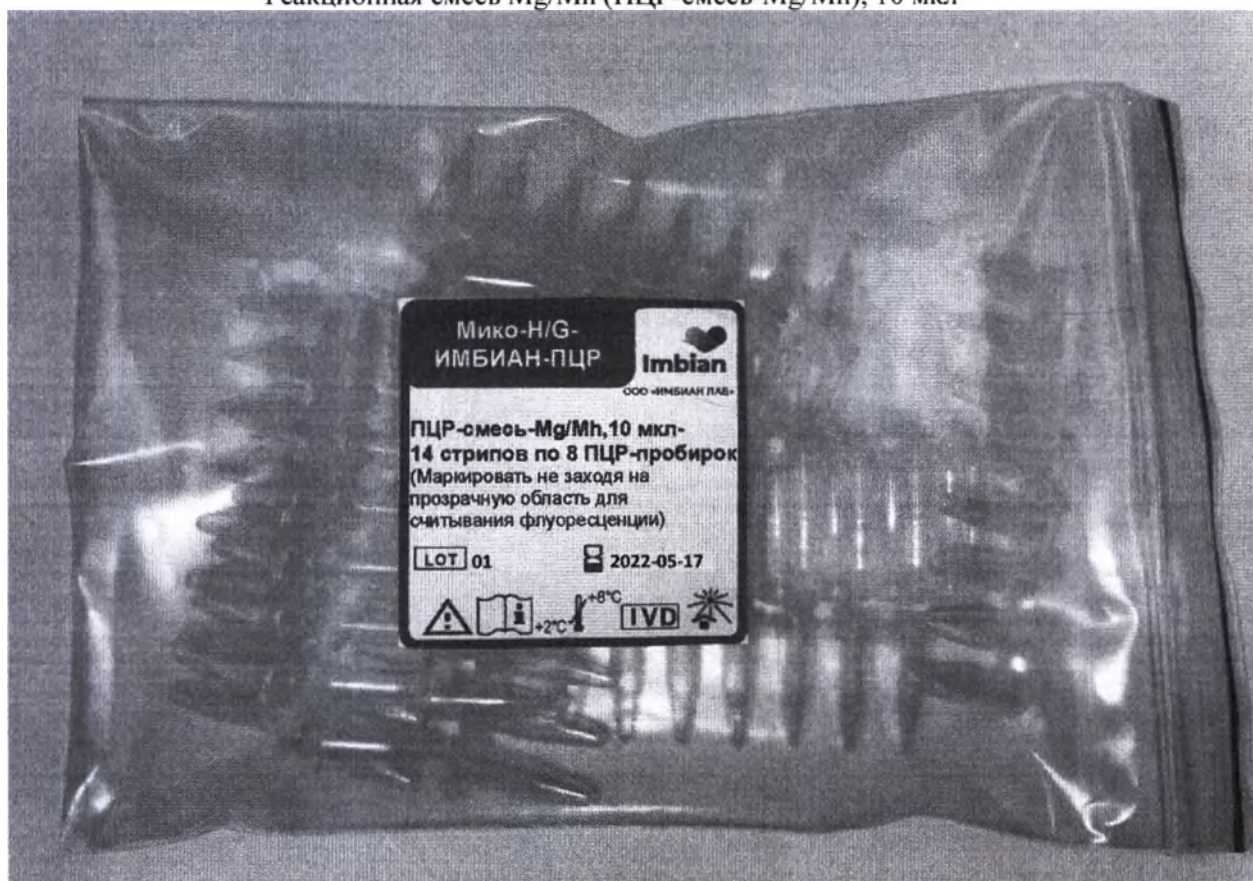

Тaq-ДНК-полимераза, 1120 мкл



Положительный контрольный образец (ПКО), 250 мкл



Внутренний контрольный образец (ВКО), 1120 мкл



Отрицательный контрольный образец (ОКО), 1500 мкл



Мико-Н/Г-ИМБИАН-ПЦР

Набор реагентов для количественного выявления методом ПЦР in vitro ДНК возбудителей инфекций *Mycoplasma genitalium* в препаратах нуклеиновых кислот, полученных их клинических образцов в режиме реального времени «Мико-Н/Г-ИМБИАН-ПЦР» по ТУ 21.20.23-119-41390295-2021

Imbian

Комплект 1

- 1 Реакционная смесь Mg/Mh (ПЦР-смесь-Mg/Mh), 10 мкл
- 2 Taq-ДНК-полимераза, 1120 мкл
- 3 Положительный контрольный образец (ПКО), 250 мкл
- 4 Внутренний контрольный образец (ВКО), 1120 мкл
- 5 Отрицательный контрольный образец (ОКО), 1500 мкл
- 6 Вкладыш с данными контрольных образцов
- 7 Инструкция

Замораживать не допускается
Только для in vitro диагностики.
ТУ 21.20.23-119-41390295-2021
для профессионального применения

14 стрипов по
8 ПЦР-пробирок
1 пробирка
1 пробирка
2 пробирки
1 пробирка
1 шт
1 шт

ПУ № XXX XXXX/XXXXX

LOT 01

REF 01

2021-05-17

2022-05-17

IVD


Σ 112 +2°C

+8°C

ООО «ИМБИАН ЛАБ»
 630558 Новосибирская обл.
 Г.О. Рабочий поселок Колывань,
 РП Колывань, ул. Садовая, д. 2/7,
 этаж 2, комната 2
 8-800-600-60-77, info@imbian.ru

Комплект 2:

Реакционная смесь Mg/Mh (ПЦР-смесь- Mg/Mh), 10 мкл

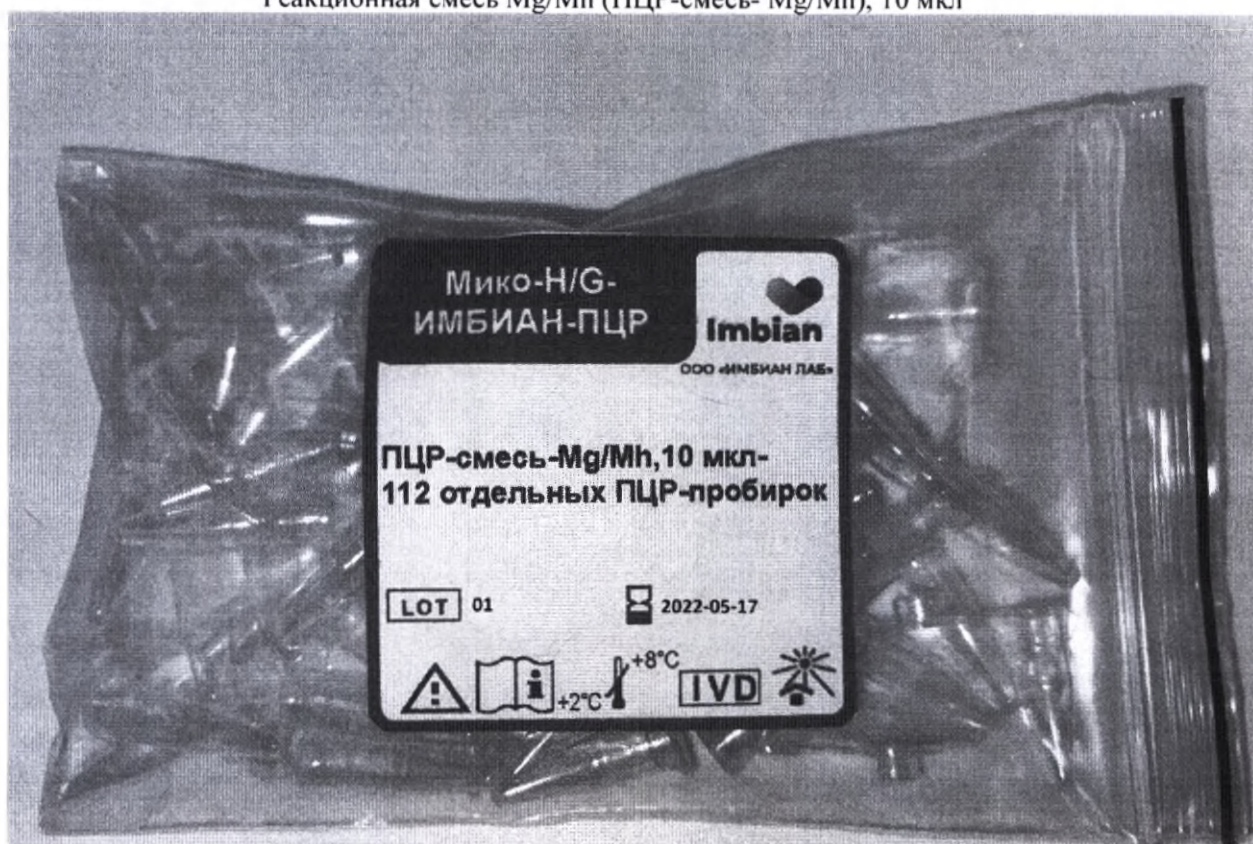

Тaq-ДНК-полимераза, 1120 мкл



Положительный контрольный образец (ПКО), 250 мкл



Внутренний контрольный образец (ВКО), 1120 мкл



Отрицательный контрольный образец (ОКО), 1500 мкл



Мико-Н/Г-ИМБИАН-ПЦР

Комплект 2

- 1 Реакционная смесь Mg/Mh (ПЦР-смесь-Mg/Mh), 10 мкл
- 2 Taq-ДНК-полимераза, 1120 мкл
- 3 Положительный контрольный образец (ПКО), 250 мкл
- 4 Внутренний контрольный образец (ВКО), 1120 мкл
- 5 Отрицательный контрольный образец (ОКО), 1500 мкл
- 6 Вкладыш с данными контрольных образцов
- 7 Инструкция

Замораживать не допускается.
Только для in vitro диагностики.
ТУ 21.20.23-119-41390295-2021
Для профессионального применения

Набор реагентов для количественного выявления методом ПЦР in vitro ДНК возбудителей инфекций *Mycoplasma genitalium* в препаратах нуклеиновых кислот, полученных их клинических образцов в режиме реального времени «Мико-Н/Г-ИМБИАН-ПЦР» по ТУ 21.20.23-119-41390295-2021

112 отдельных ПЦР пробирок

1 пробирка

1 пробирка

2 пробирки

1 пробирка

1 шт

1 шт

ПУ № XXX XXXX/XXXXXX

LOT 01

REF 01

2021-05-17


2022-05-17

Imbian


ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Новосибирская обл.
Г.О. Рабочей поселка Болышев
Р/П. Холщовое, ул. Садовая, д. 2/7
Этаж 2, помещ. 2
8-800-600-80-77, info@imbiant.ru

ООО ЦРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

8

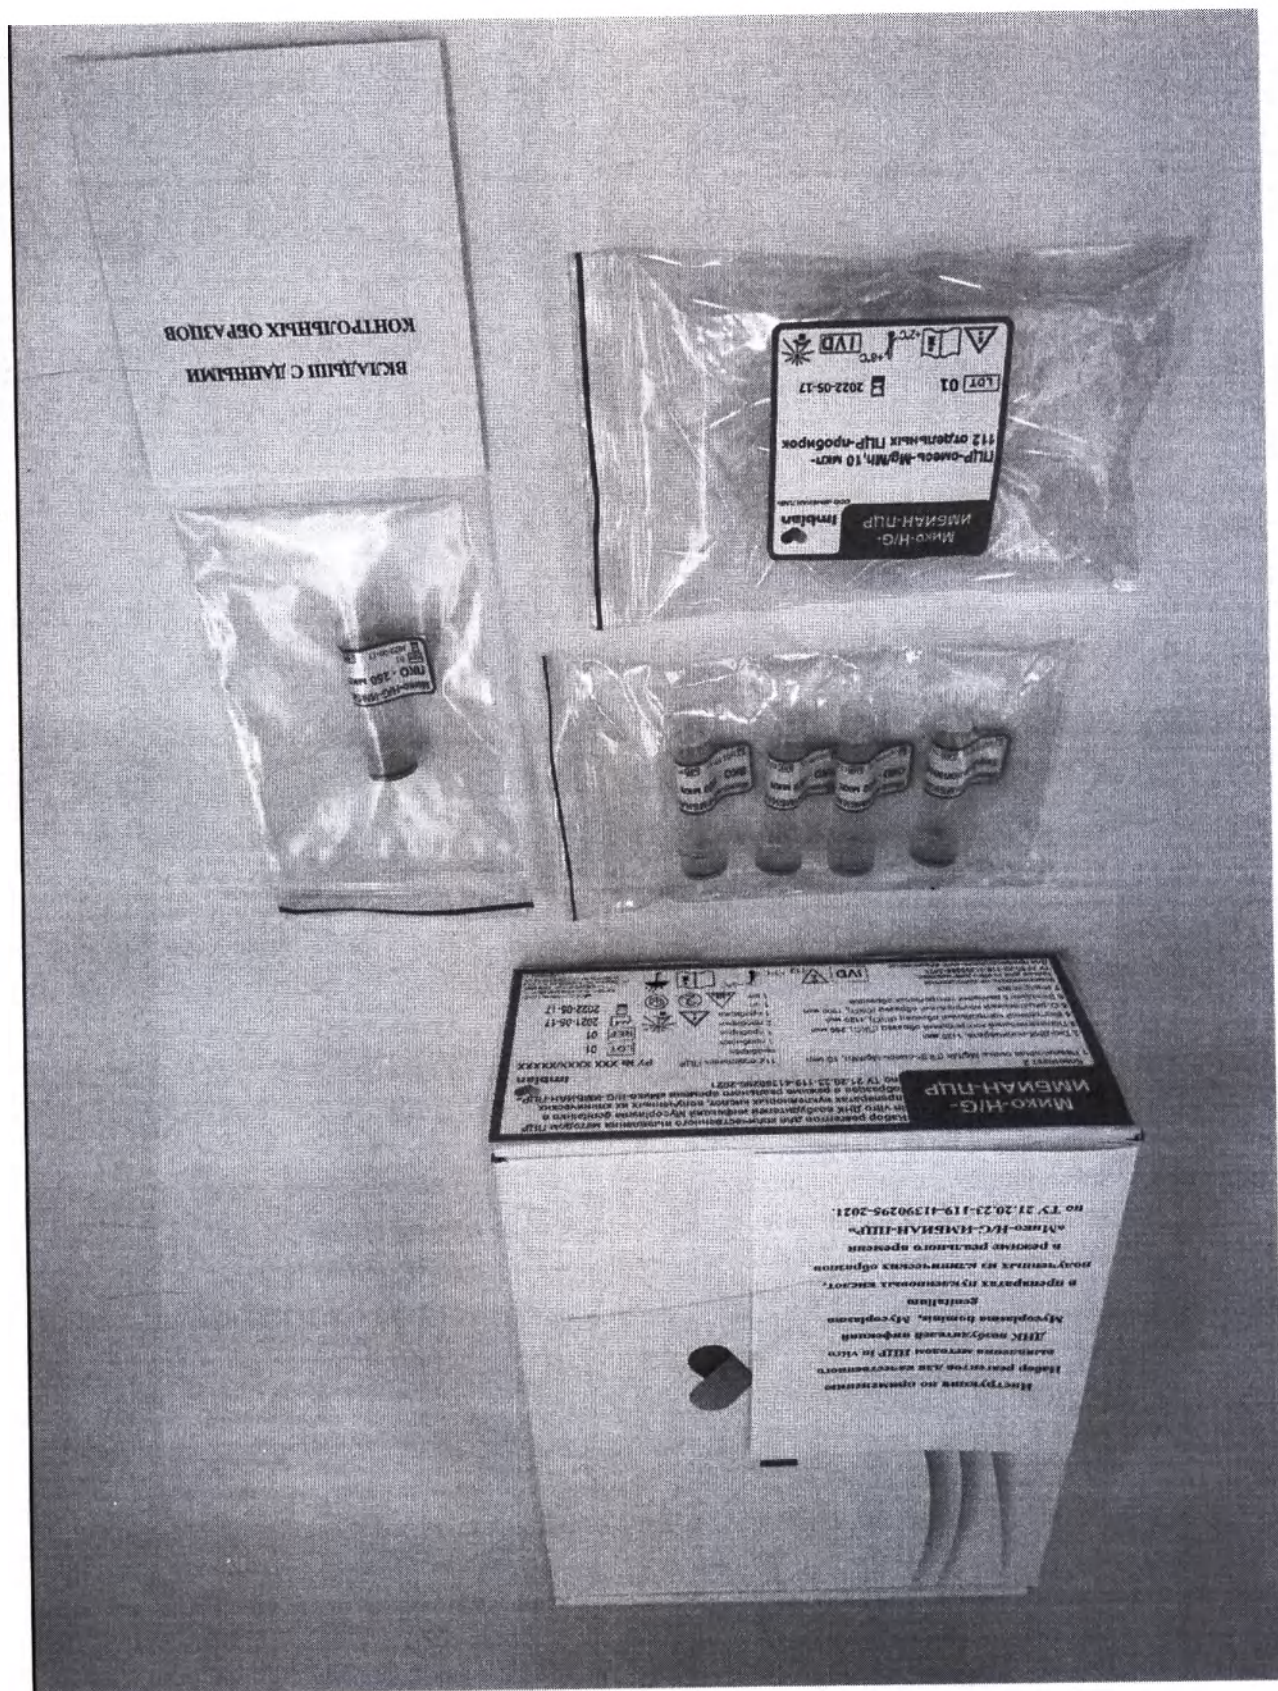


Транспортная упаковка

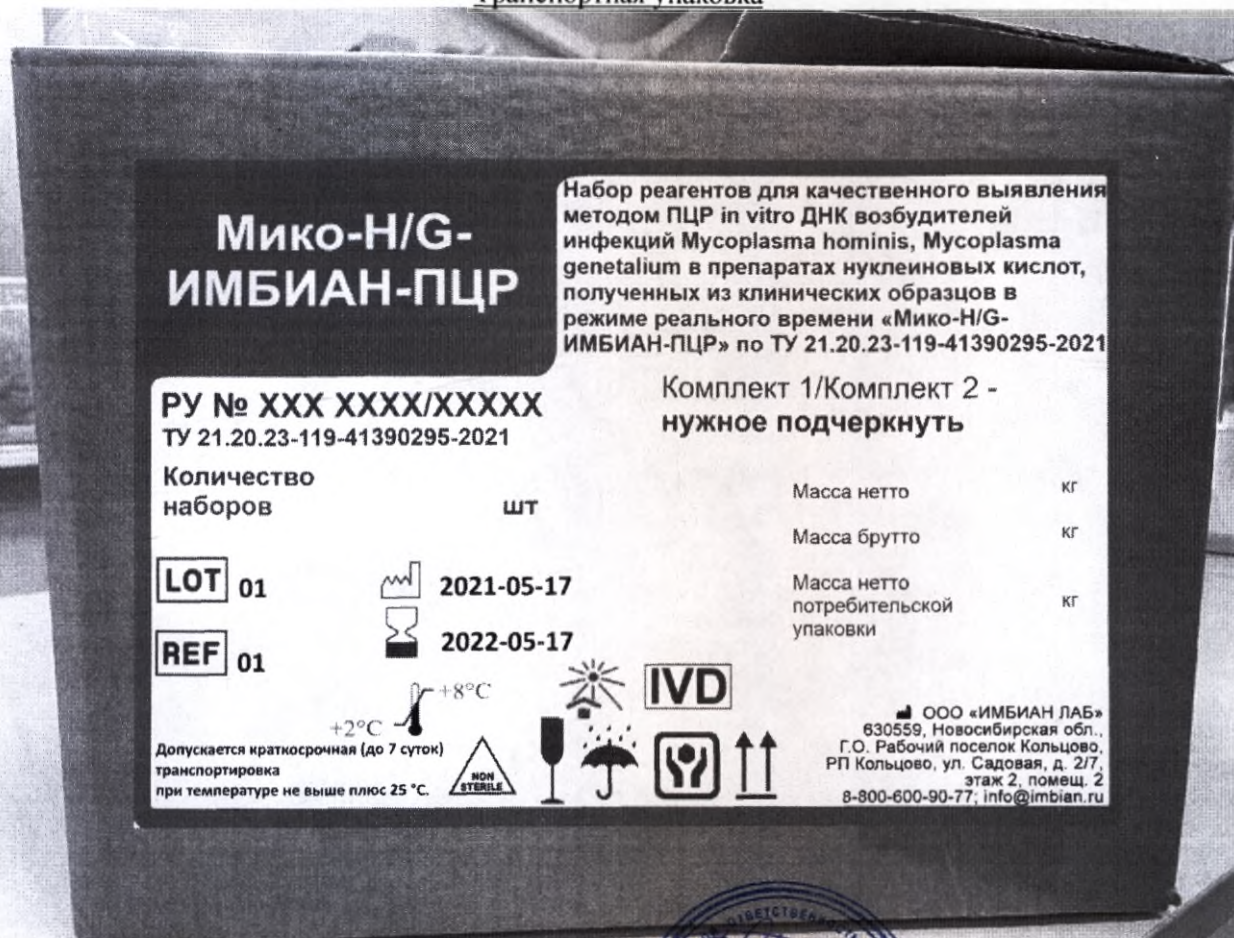

Генеральный директор ООО «ИМБИАН ЛАБ»

В.В. Осипова

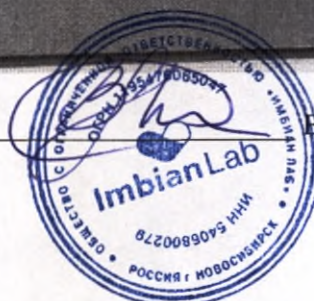

Сшито и заверено печатью 10

(десять) лист 06

Генеральный директор ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Осипова В.В.

