

« 09 » января 2023 г.



ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Рисунок 1.1 Общий вид медицинского изделия «Система интеллектуальная для анализа эндоскопических изображений PENTAX Medical SAS-M10»

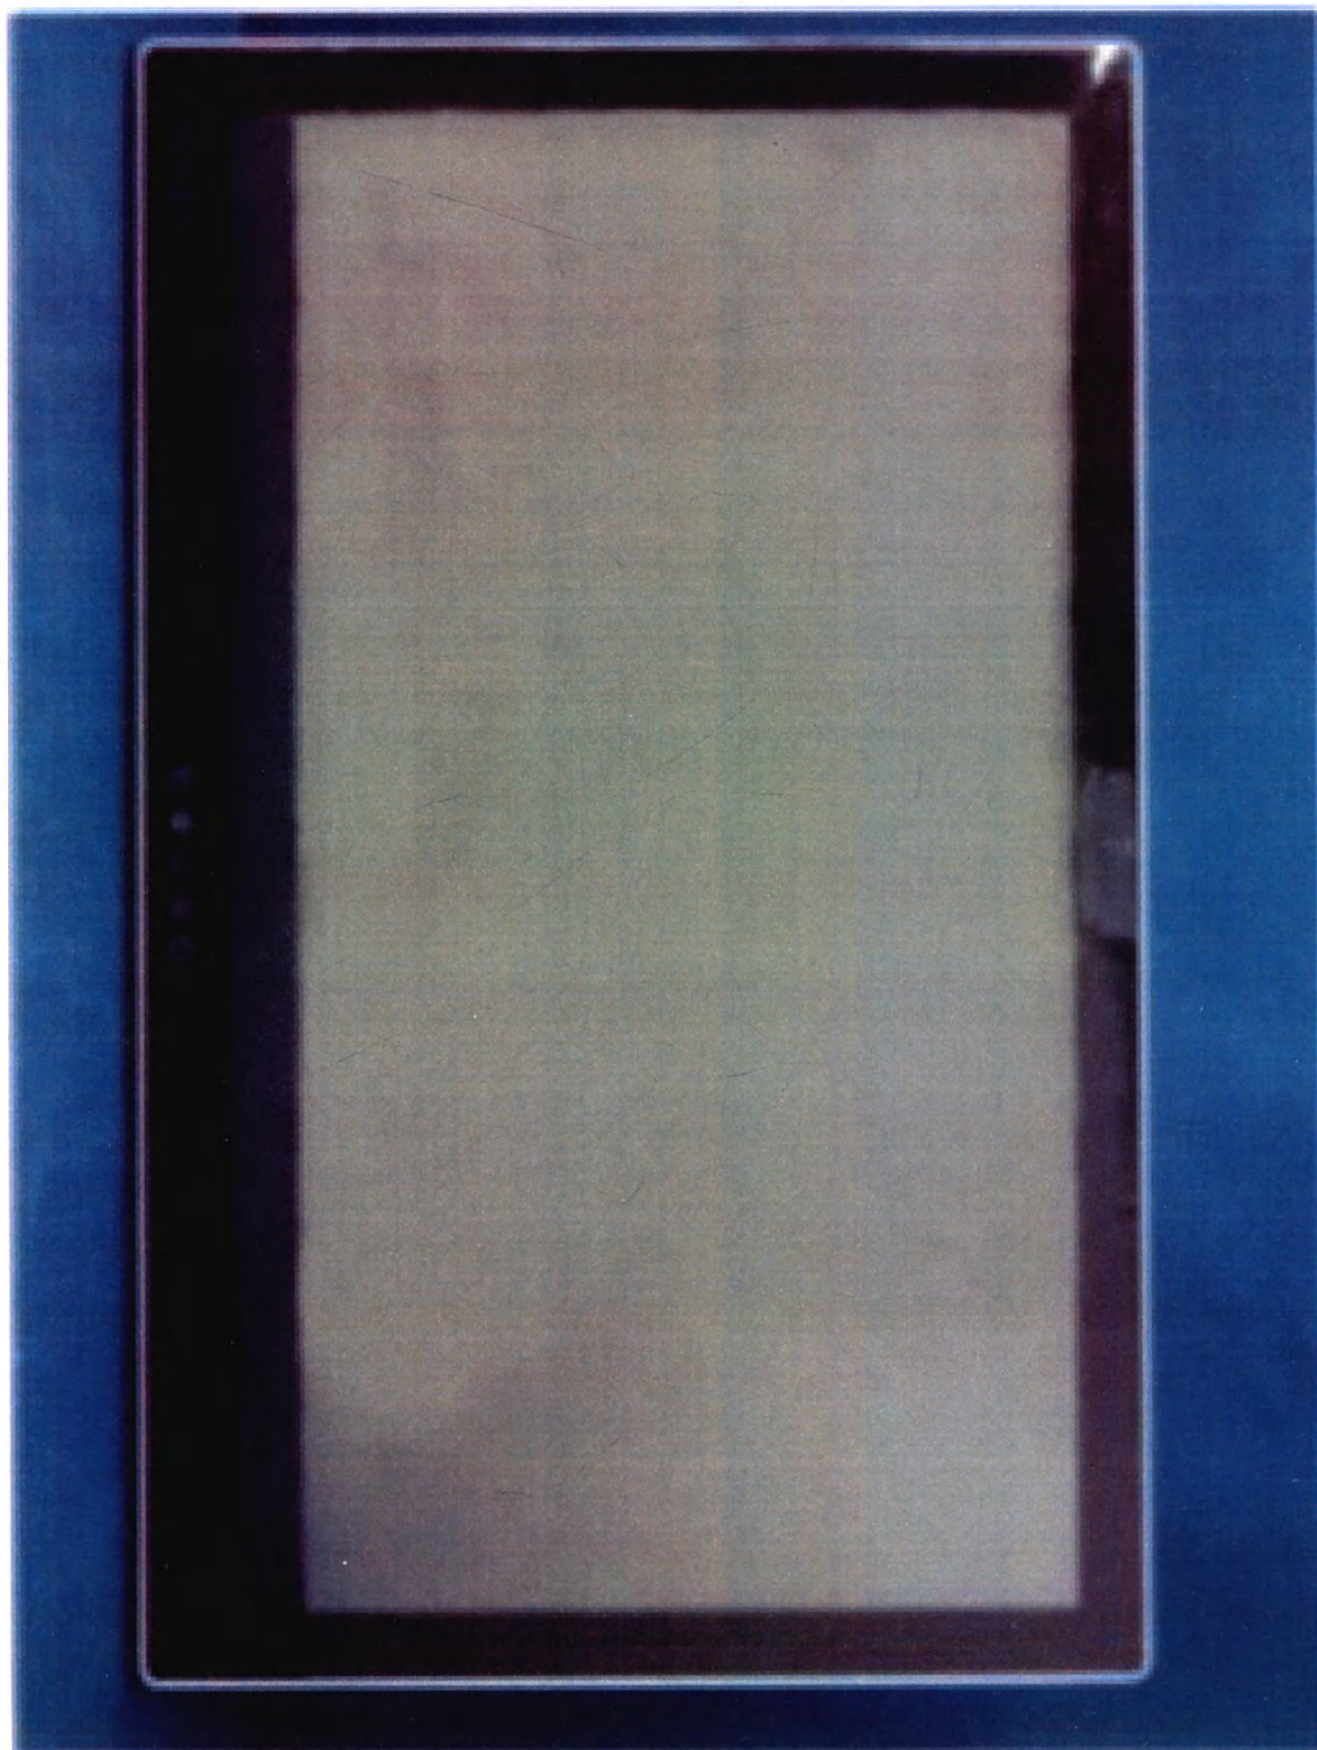


Рисунок 1.2 Общий вид медицинского изделия «Система интеллектуальная для анализа эндоскопических изображений PENTAX Medical SAS-M10»

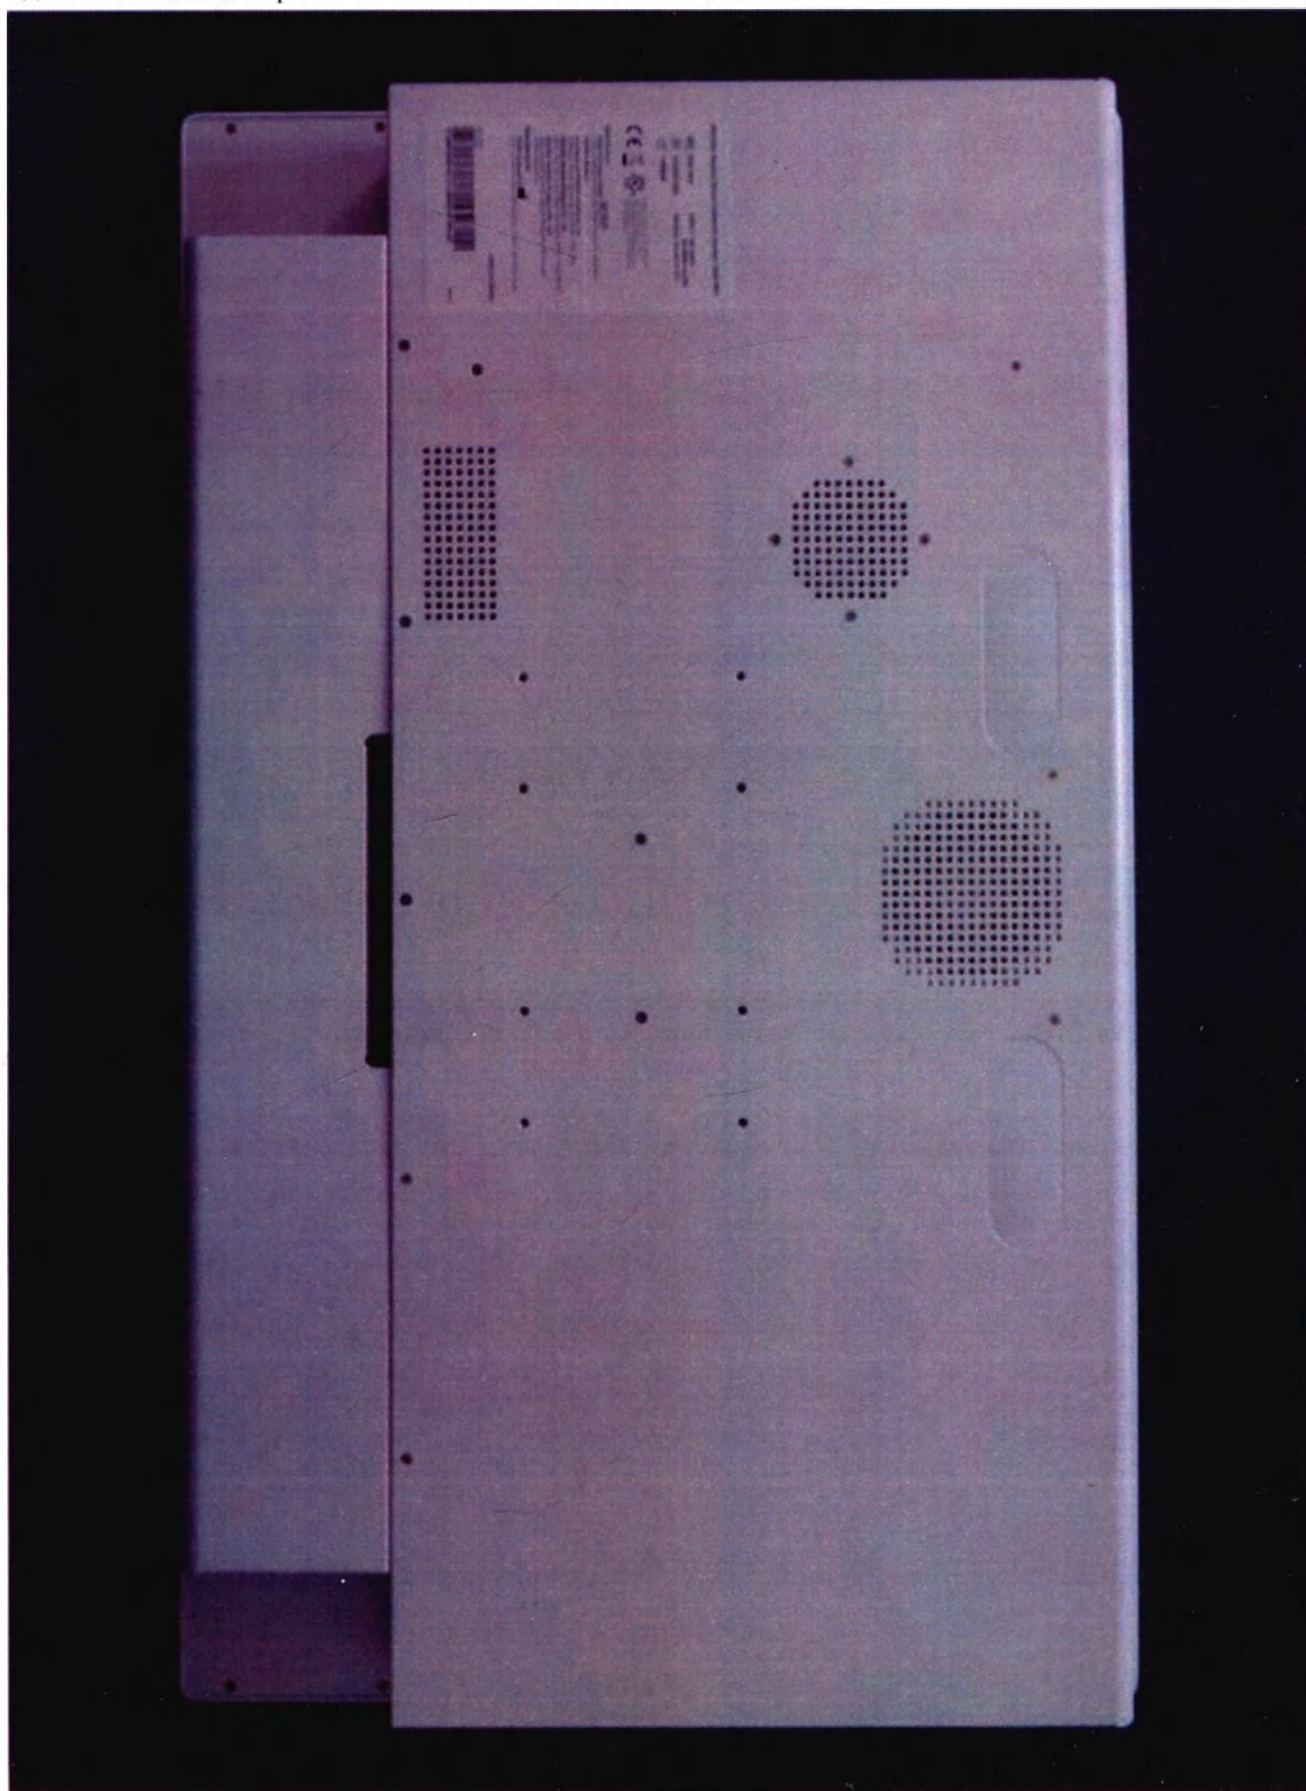


Рисунок 2. Общий вид медицинского изделия «Система интеллектуальная для анализа эндоскопических изображений PENTAX Medical SAS-M10». Кабель сетевой



Рисунок 3. «Система интеллектуальная для анализа эндоскопических изображений PENTAX Medical SAS-M10». Кабель соединительный SDI




Рисунок 4. «Система интеллектуальная для анализа эндоскопических изображений PENTAX Medical SAS-M10». Кабель соединительный DVI



Рисунок 5. Общий вид медицинского изделия «Система интеллектуальная для анализа эндоскопических изображений PENTAX Medical SAS-M10». Инструкция по применению (Руководство по аппаратному обеспечению)

APPROVED BY



Seiya Raiju,
Vice President
Global Quality Assurance & Regulatory Affairs
PENTAX Life Care Division
HOYA Corporation



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

**Система интеллектуальная для анализа эндоскопических изображений
PENTAX Medical SAS-M10**

Руководство по аппаратному обеспечению

производства компании HOYA Corporation
(ХОЯ Корпорейшн)

Рисунок 6. Общий вид медицинского изделия «Система интеллектуальная для анализа эндоскопических изображений PENTAX Medical SAS-M10». Инструкция по применению (Руководство по программному обеспечению)

APPROVED BY



Seiya Raiju,
Vice President
Global Quality Assurance & Regulatory Affairs
PENTAX Life Care Division
HOYA Corporation



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

**Система интеллектуальная для анализа эндоскопических изображений
PENTAX Medical SAS-M10**

Руководство к программному обеспечению

**производства компании HOYA Corporation
(ХОЯ Корпорейши)**

Рисунок 7. Общий вид медицинского изделия «Система интеллектуальная для анализа эндоскопических изображений PENTAX Medical SAS-M10». Подставка монитора

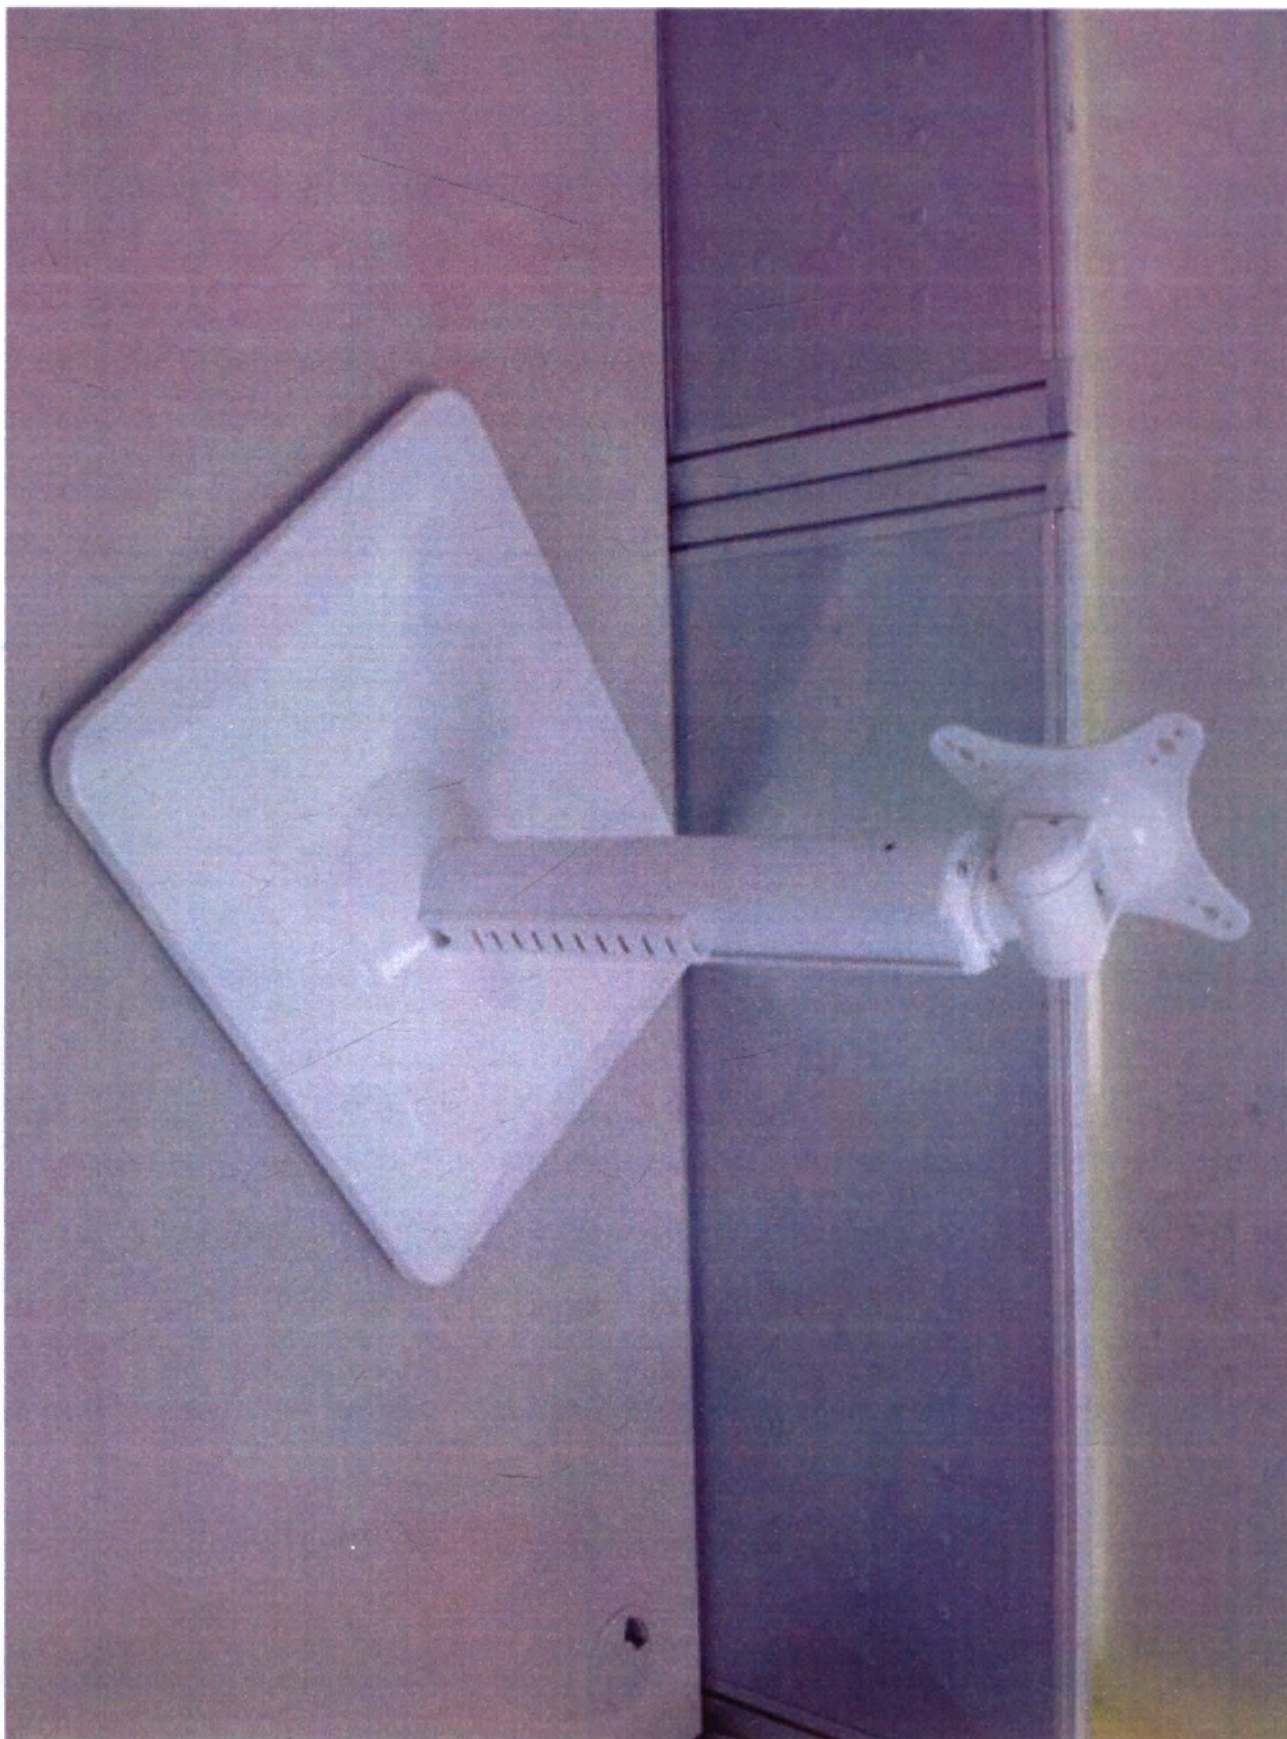


Рисунок 8. «Система интеллектуальная для анализа эндоскопических изображений PENTAX Medical SAS-M10». Маркировка



Рисунок 9. Система интеллектуальная для анализа эндоскопических изображений PENTAX Medical SAS-M10». Изображение со стороны разъемов.

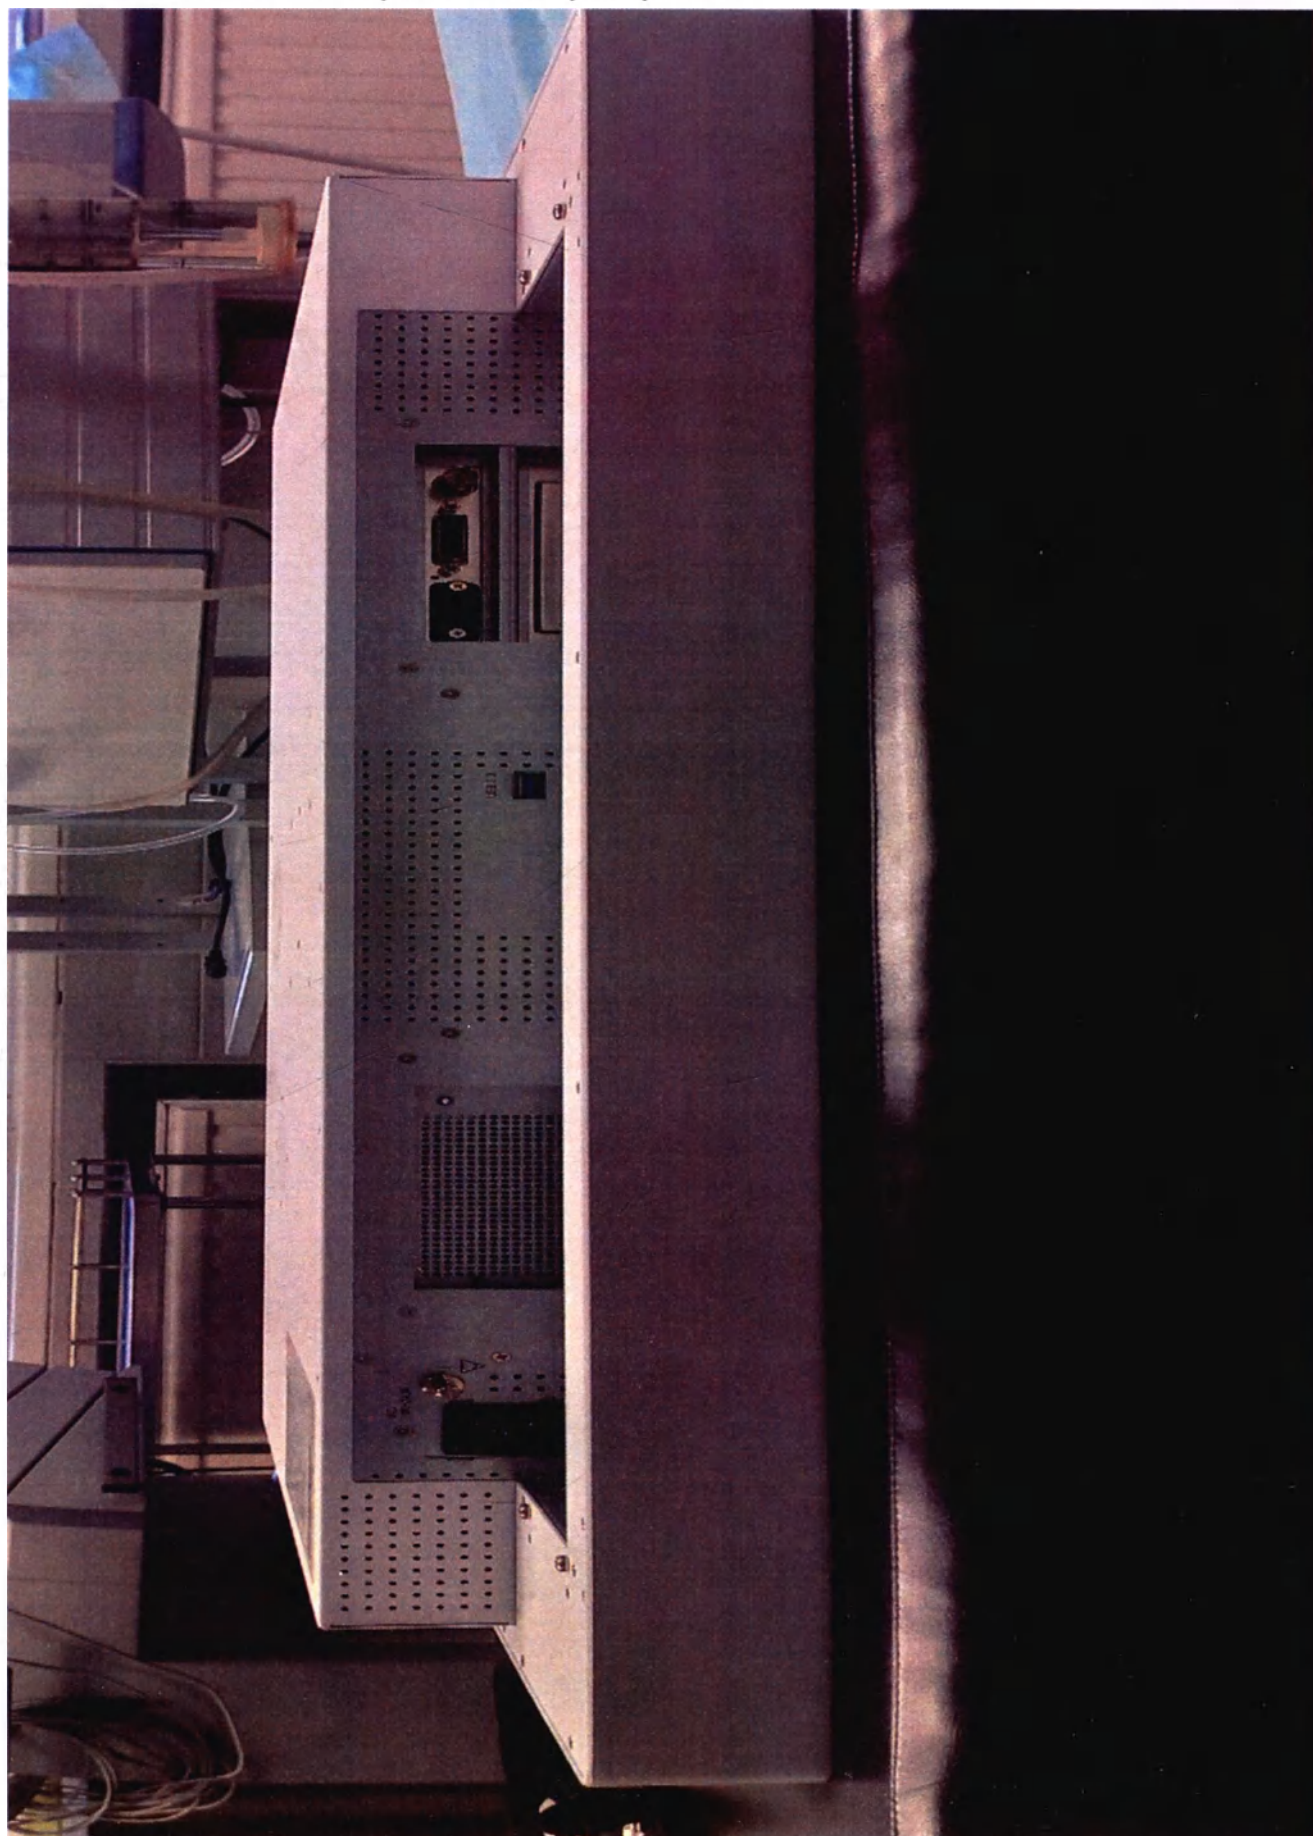


Рисунок 10 «Система интеллектуальная для анализа эндоскопических изображений PENTAX Medical SAS-M10». Изображение со стороны разъемов (увеличенное изображение)

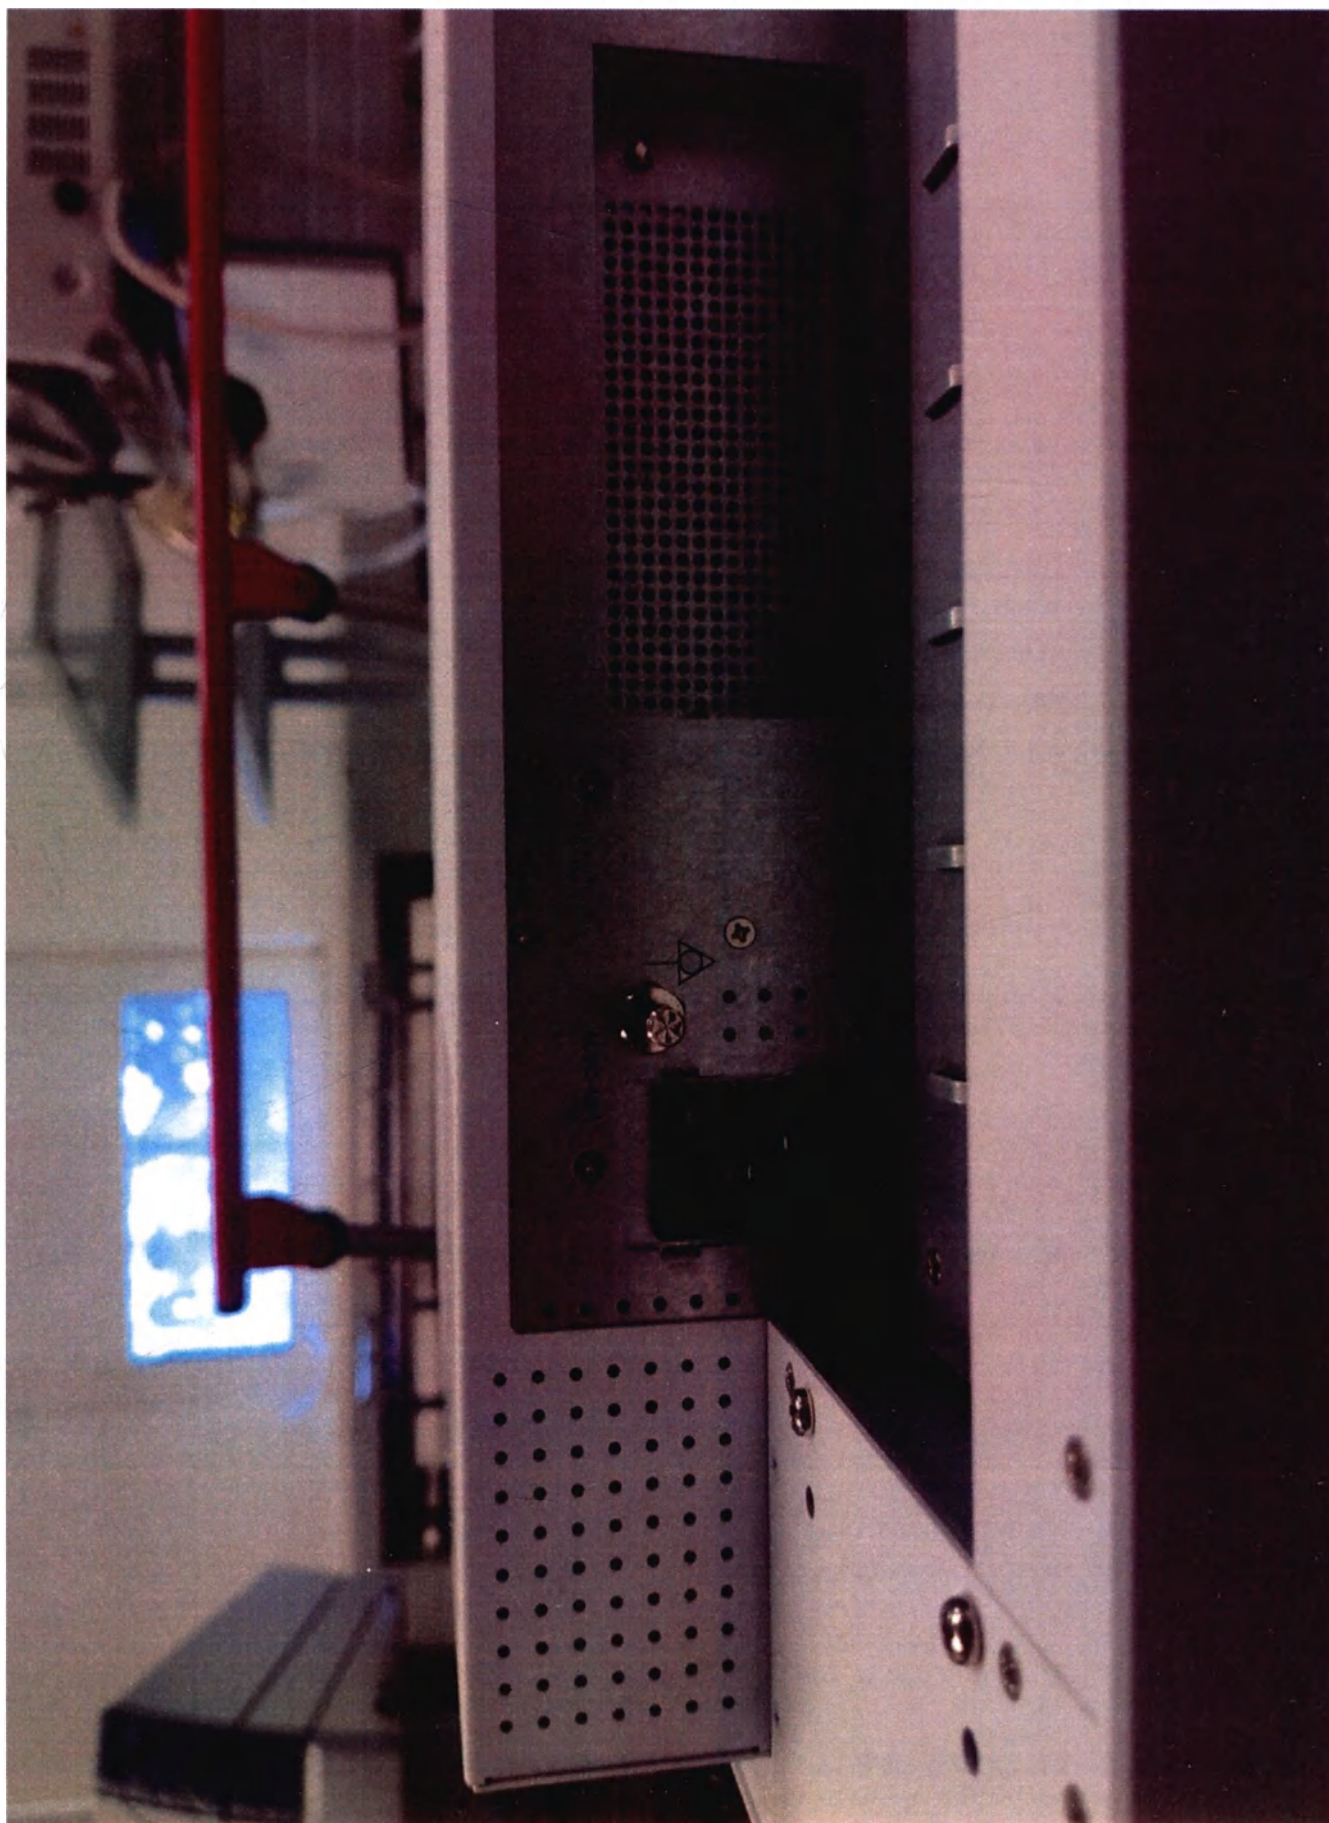


Рисунок 11. «Система интеллектуальная для анализа эндоскопических изображений PENTAX Medical SAS-M10». Изображение со стороны разъемов (увеличенное изображение)

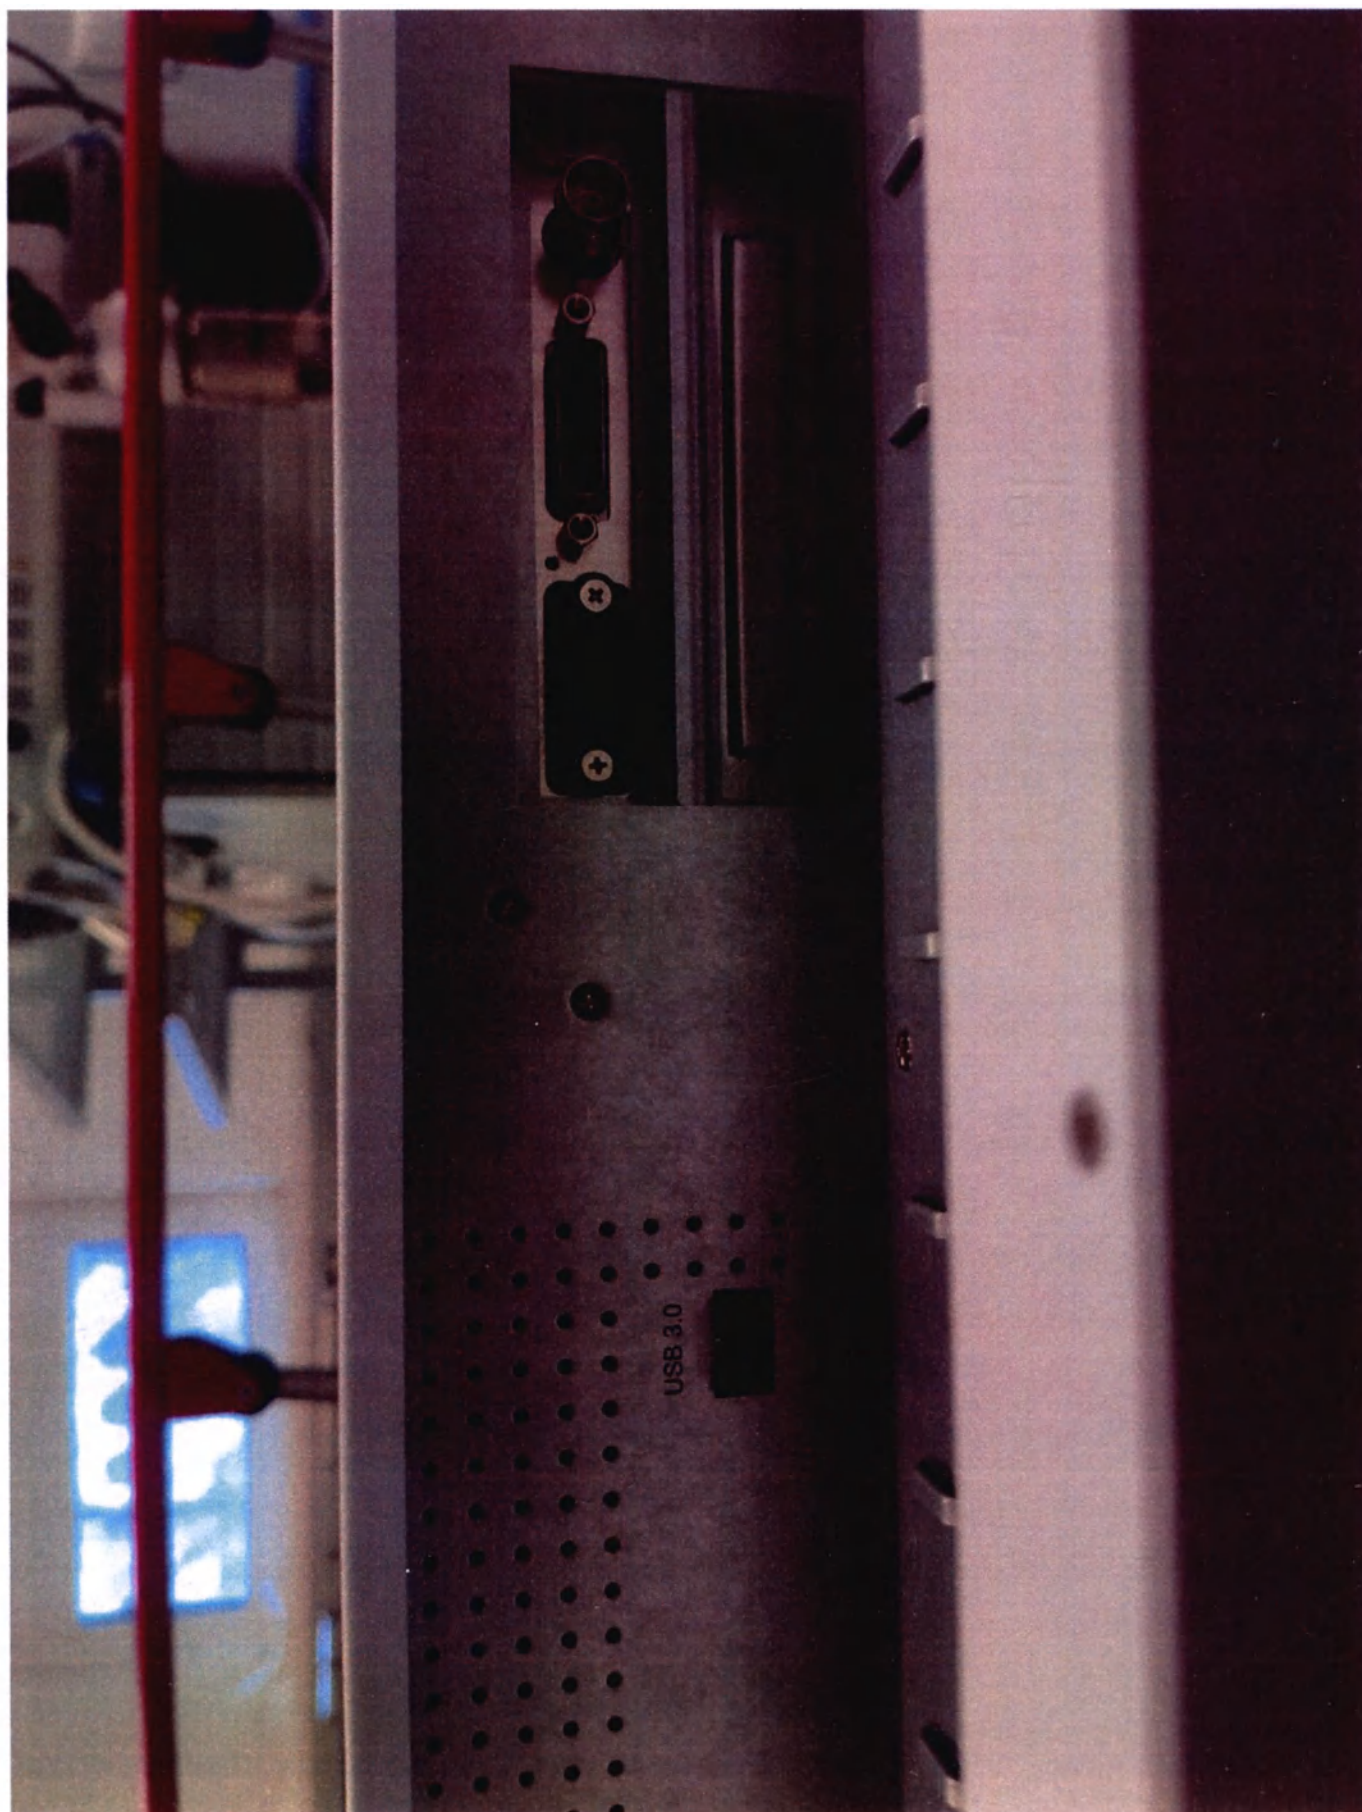


Рисунок 12. «Система интеллектуальная для анализа эндоскопических изображений PENTAX Medical SAS-M10». Изображение упаковки





Рисунок 13. «Система интеллектуальная для анализа эндоскопических изображений PENTAX Medical SAS-M10». Изображение упаковки (Кабель сетевой)

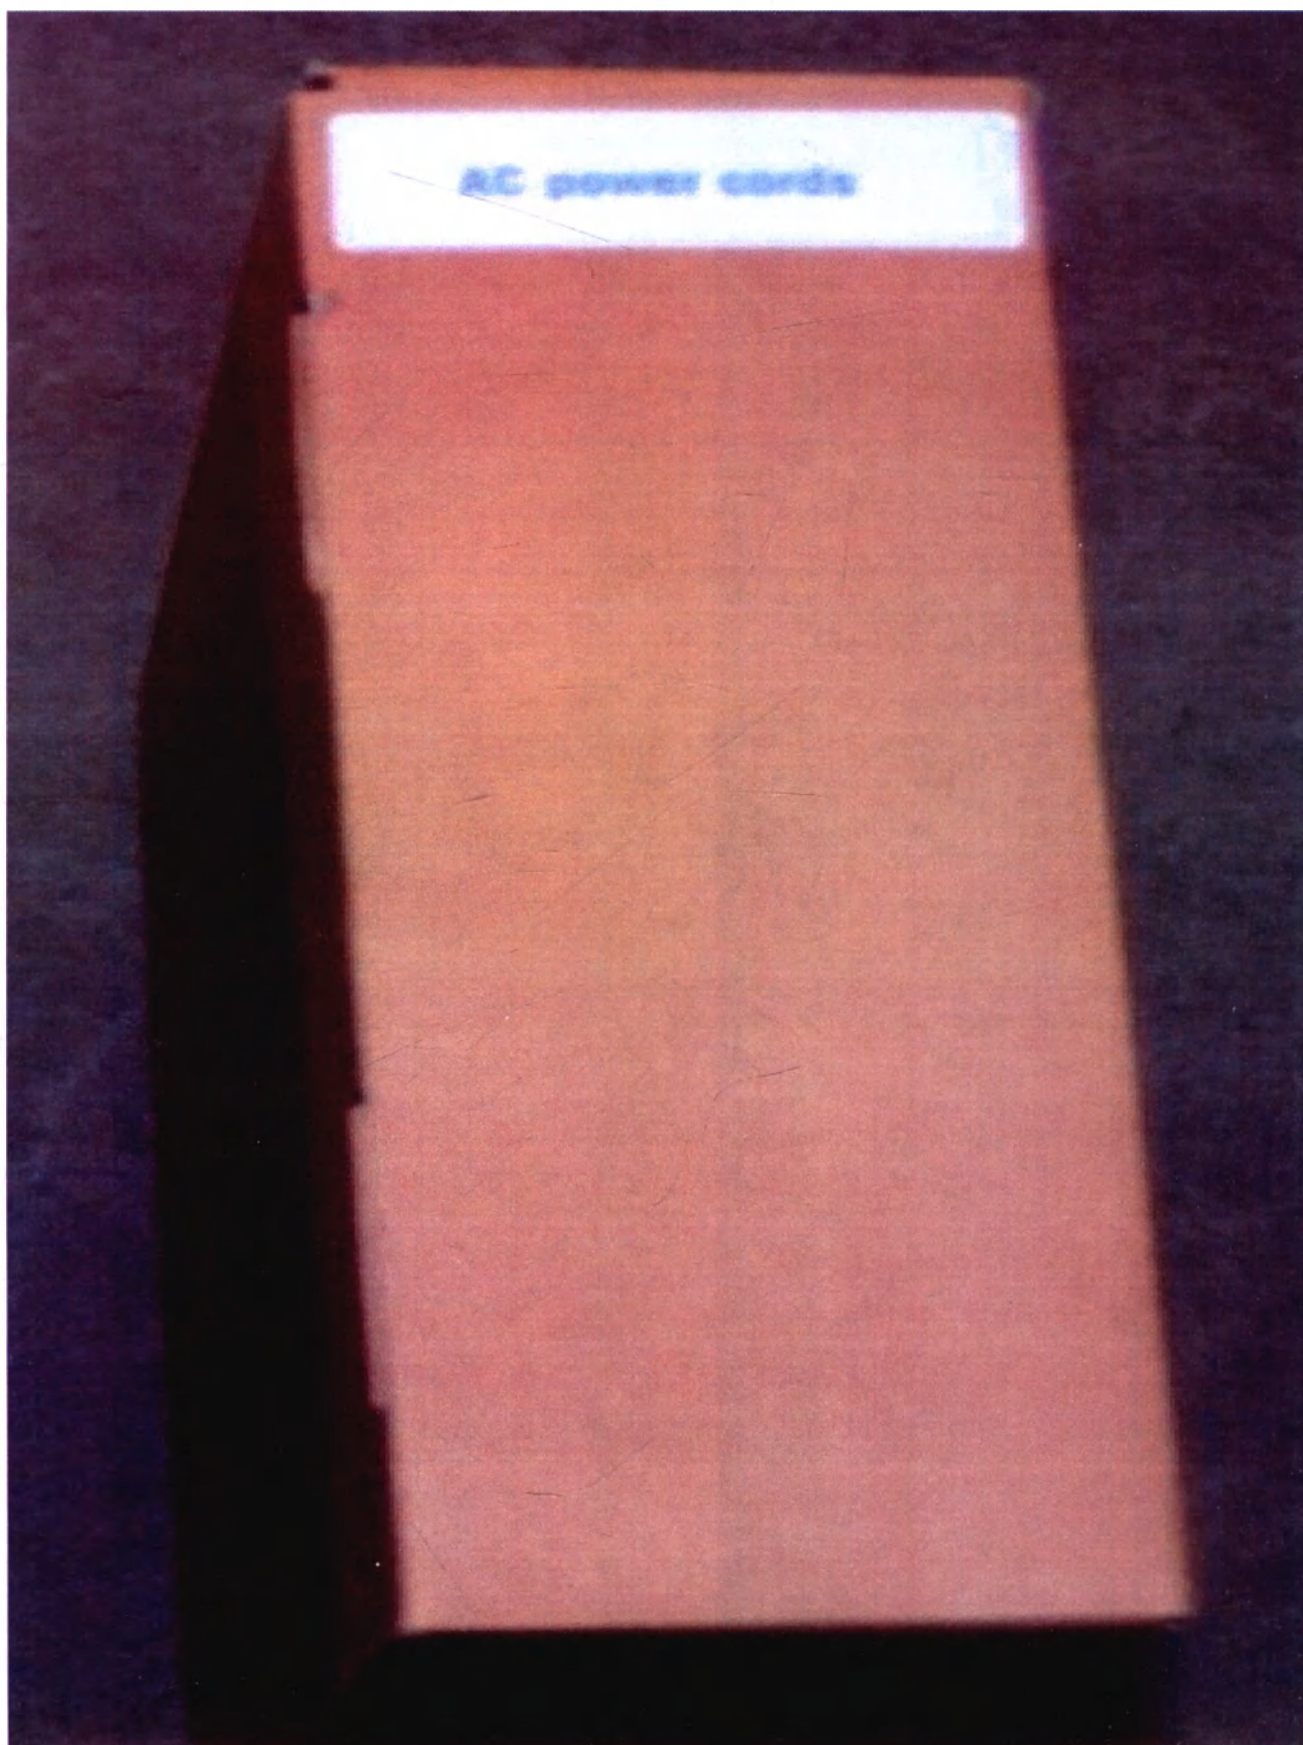


Рисунок 14. «Система интеллектуальная для анализа эндоскопических изображений PENTAX Medical SAS-M10». Изображение упаковки (Кабель соединительный DVI, Кабель соединительный SDI, Руководство по аппаратному обеспечению, Руководство по программному обеспечению)


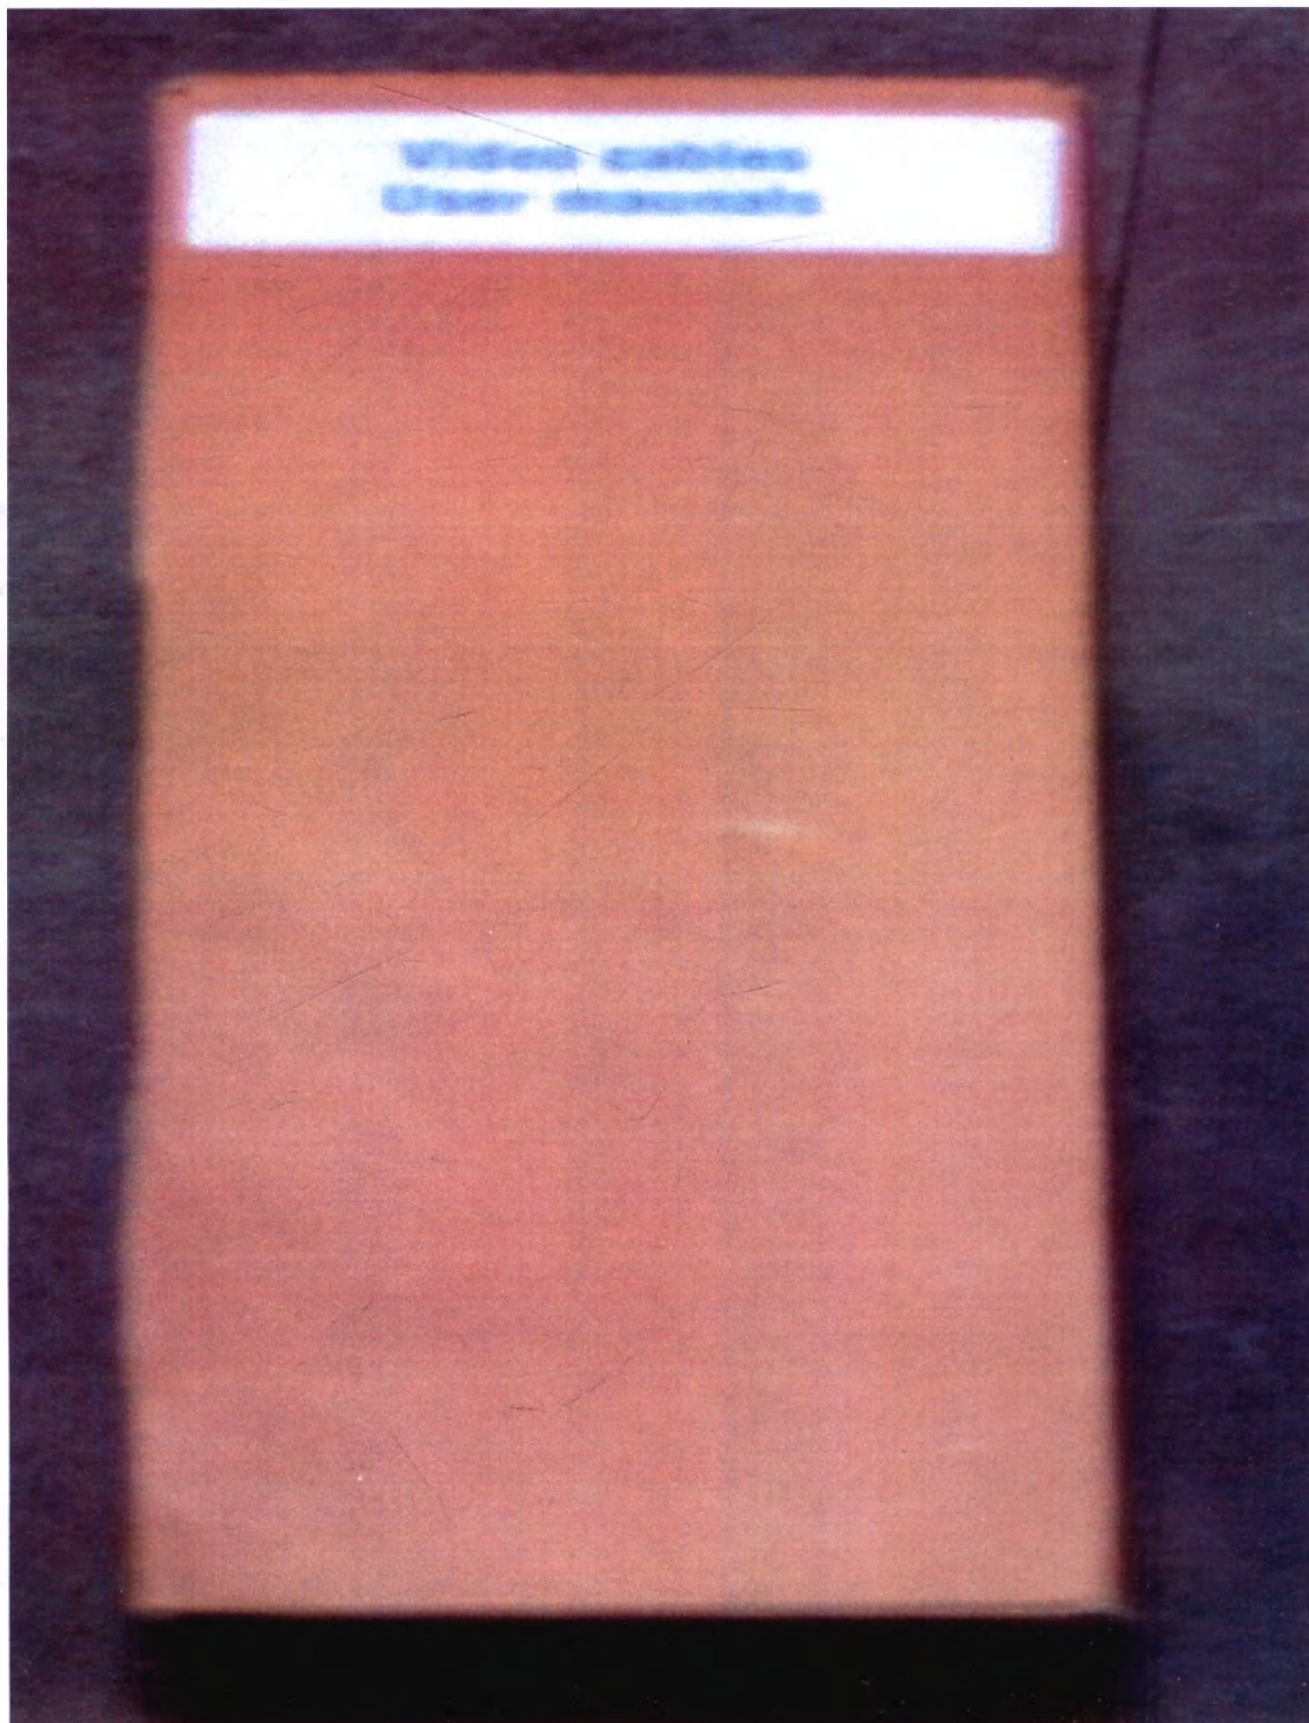


Рисунок 15. «Система интеллектуальная для анализа эндоскопических изображений PENTAX Medical SAS-M10». Изображение упаковки (Подставка монитора)

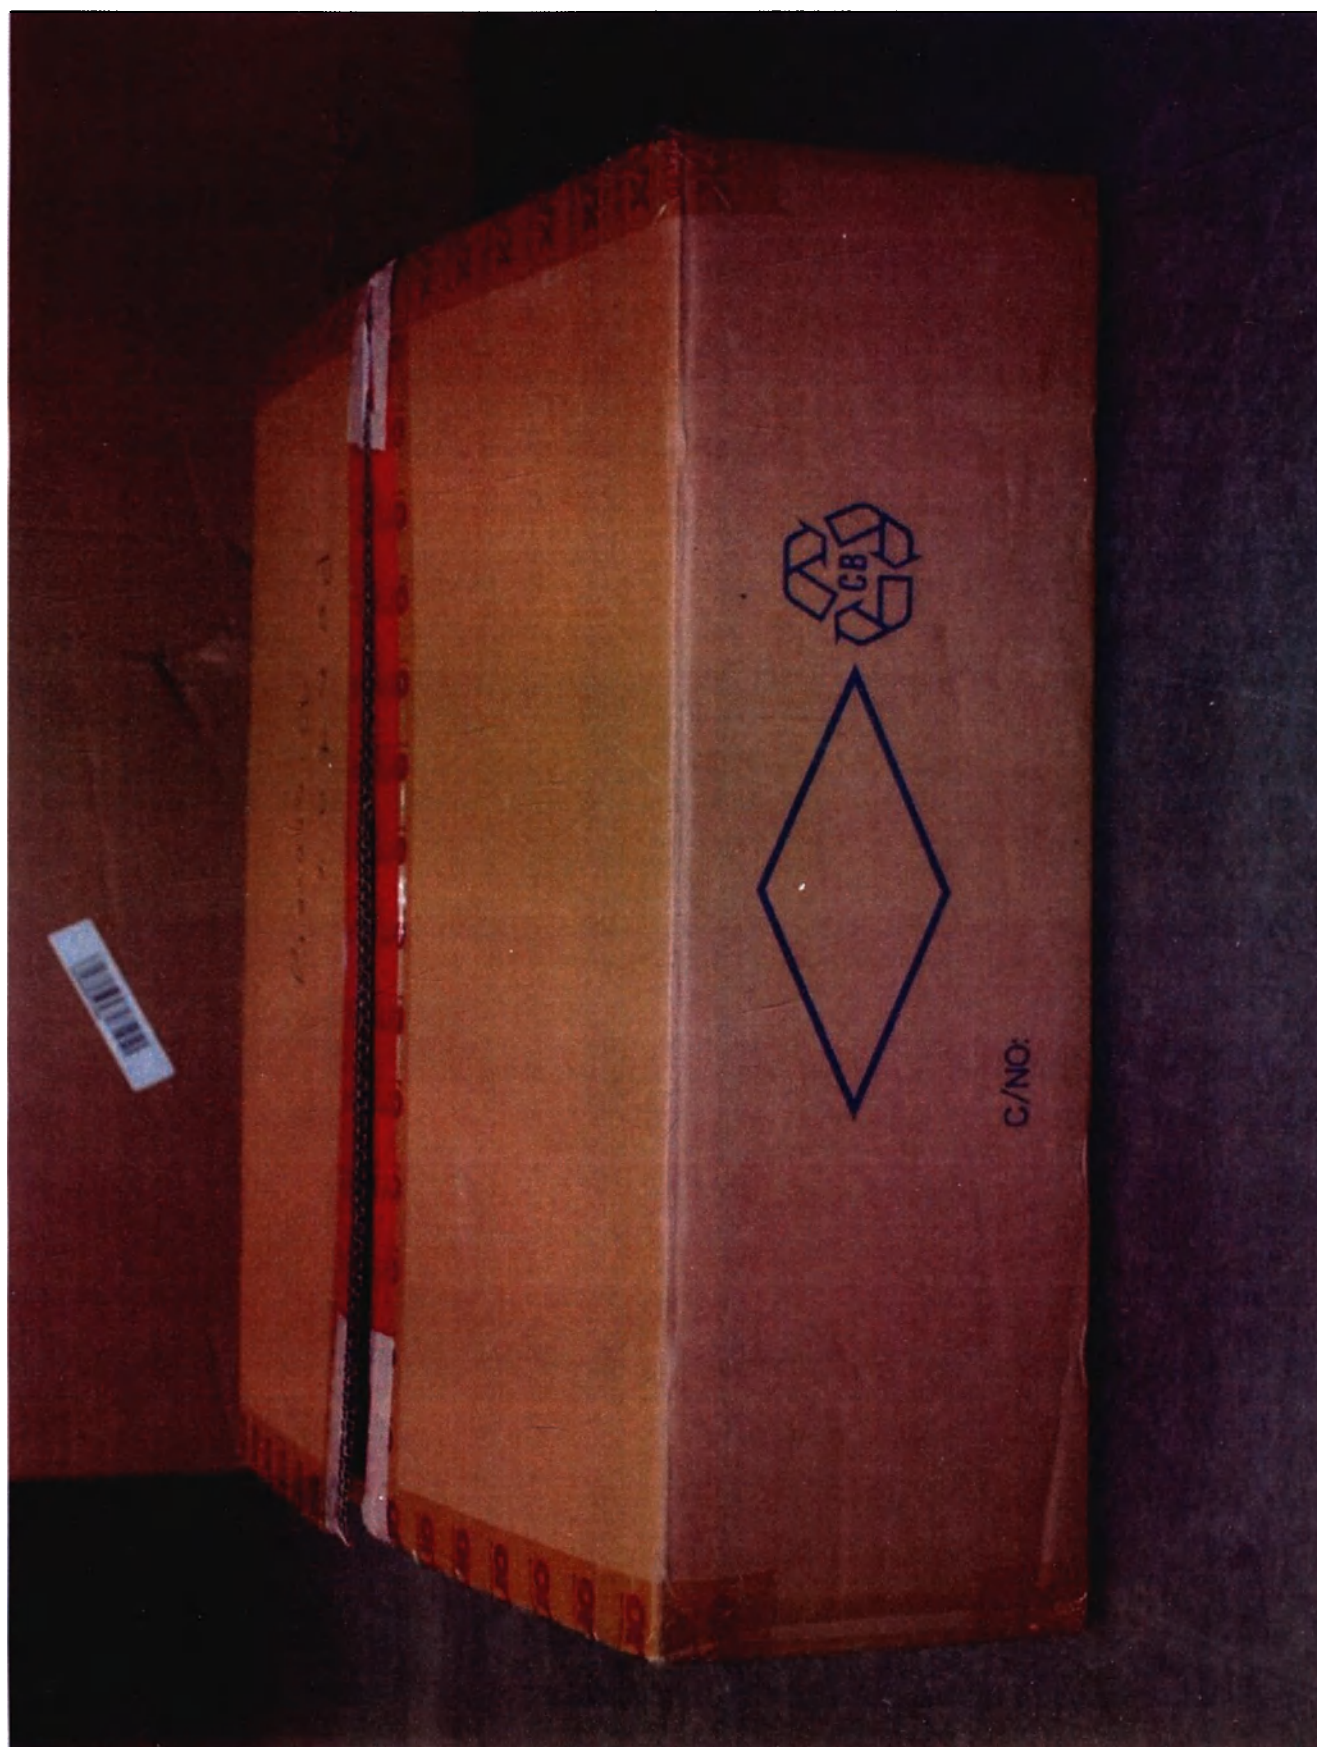

Пронумеровано, прошнуровано, прошито
и скреплено печатью

18 (Восемнадцать) листов

Генеральный директор

ООО «ПЕНТАКС МЕДИКАЛ РУС»

 Е.Т. Медведева

