


Руководитель направления по регистрации
продукции для in vitro диагностики,
иммунохимия, гематология и гемостаз
«Сименс Здравоохранение»


Чигринец Е.А.
2022 г.

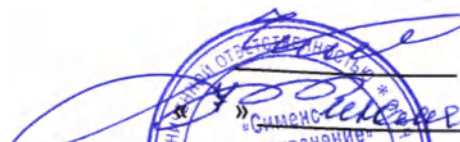

Фотографические изображения медицинского изделия для диагностики in vitro

**Pearent Dade Actin Activated Cephaloplastin для определения активированного
частичного тромбопластинового времени**

**«Сименс Хелскеа Диагностикс Продактс ГмбХ» (Siemens Healthcare Diagnostics Products
GmbH), Германия**

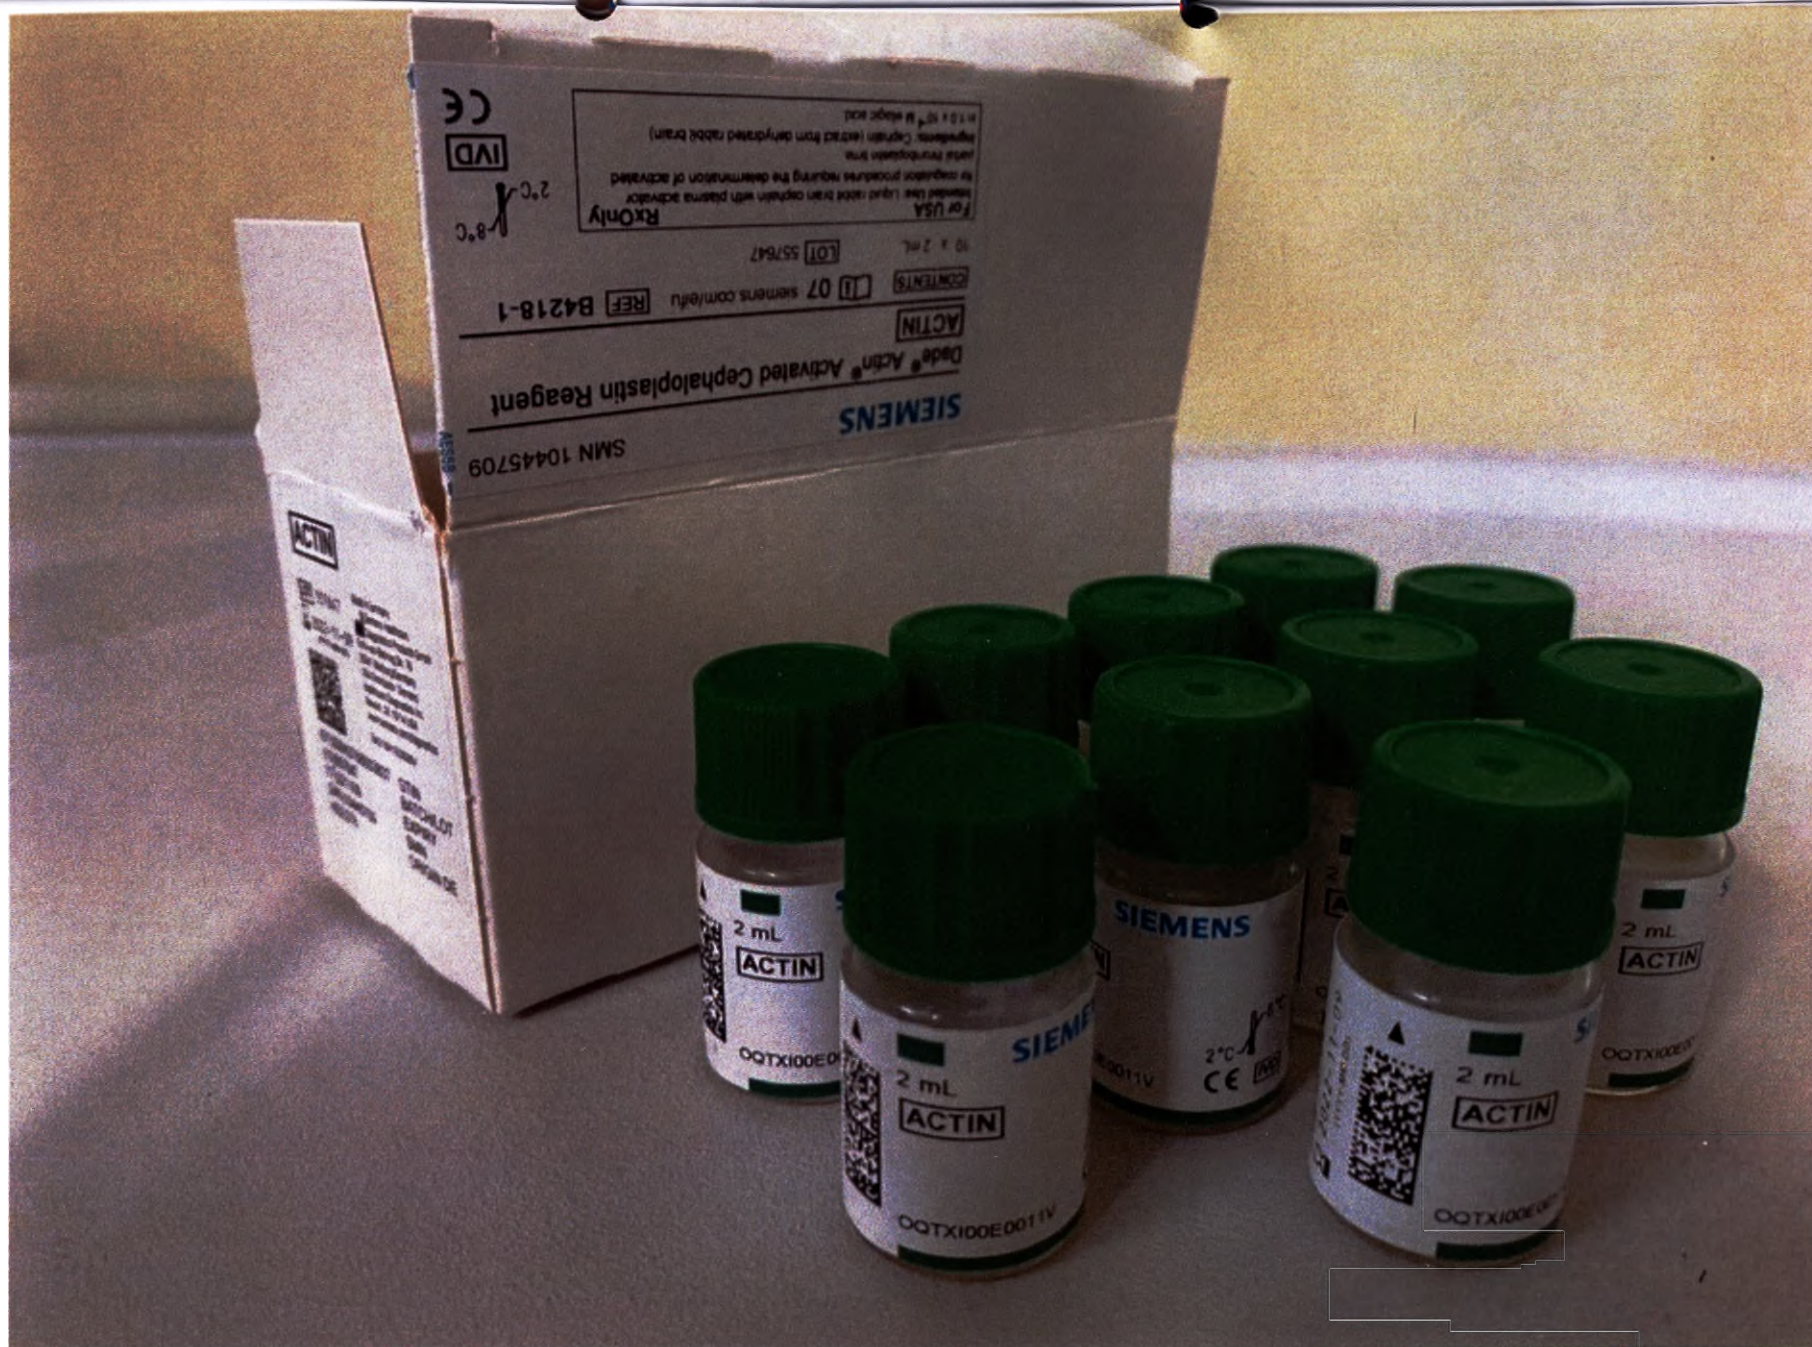


Рисунок 1. Реагент Dade Actin Activated Cephaloplastin для определения активированного частичного тромбопластинового времени: общий вид изделия



Рисунок 2. Реагент Dade Actin Activated Cephaloplastin для определения активированного частичного тромбопластинового времени: картонная коробка.

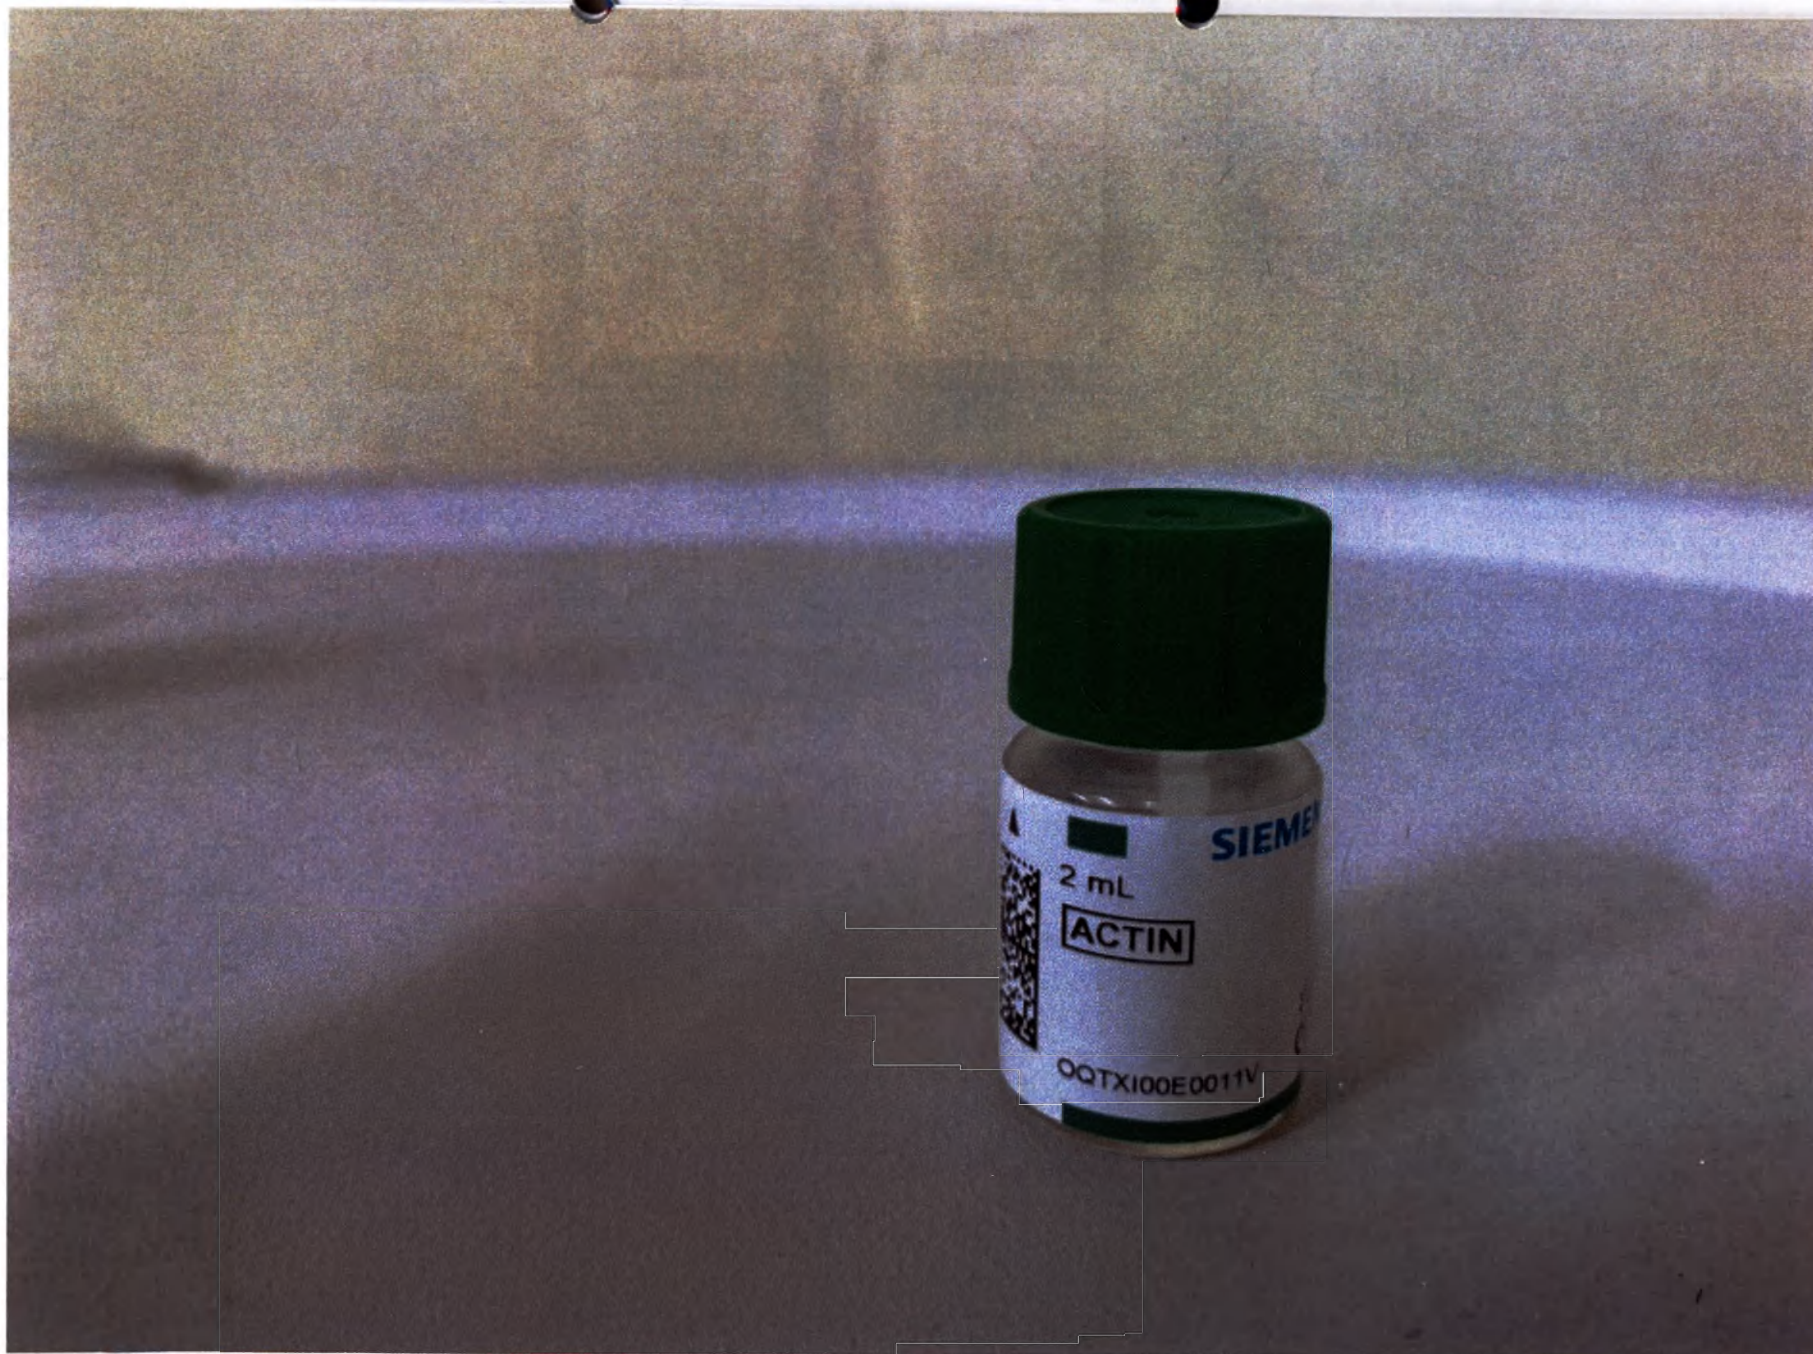


Рисунок 3. Реагент Dade Actin Activated Cephaloplastin для определения активированного частичного тромбопластинового времени: флакон с реагентом



Всего прошито и пронумеровано
листа (ов).

ООО «Сименс Здоровоохранение»