



Научно-производственное предприятие

"ТЕХНОМЕДИКА"

Общество с ограниченной ответственностью

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО НПП «ТЕХНОМЕДИКА»

Ованесов Н.Е.



23 2022г.

ФОТО

медицинского изделия

**«Анализатор гипербилирубинемии у новорожденных транскутанный
скрининговый фотометрический автоматический двухканальный
двухволновый АГФн-04 - «НПП-ТМ» по ТУ 9443-006-11254896-2004
с принадлежностями**

Производитель ООО НПП «ТЕХНОМЕДИКА»

Оглавление

- Фото 1 Анализатор гипербилирубинемии у новорожденных транскутанный скрининговый фотометрический автоматический двухканальный двухволновый АГФн-04 - «НПП-ТМ» с принадлежностями:
- 1- Анализатор гипербилирубинемии у новорожденных транскутанный скрининговый фотометрический автоматический двухканальный двухволновый АГФн-04 - «НПП-ТМ»;
 - 2- Футляр с контрольными имитаторами КИ1, КИ2;
 - 3- Элемент питания постоянного напряжения 1,5в (в комплекте 3 шт.).
- Фото 2 Анализатор гипербилирубинемии у новорожденных транскутанный скрининговый фотометрический автоматический двухканальный двухволновый АГФн-04 - «НПП-ТМ» (лицевая сторона)
- Фото 3 Анализатор гипербилирубинемии у новорожденных транскутанный скрининговый фотометрический автоматический двухканальный двухволновый АГФн-04 - «НПП-ТМ» со снятой крышкой. На тыльной стороне крепится этикетка изделия с заводским номером.
- Фото 4 Футляр с контрольными имитаторами КИ1, КИ2 (в открытом виде).
- Фото 5 Футляр с контрольными имитаторами КИ1 , КИ2 (тыльная сторона). На тыльной стороне крепится этикетка изделия.

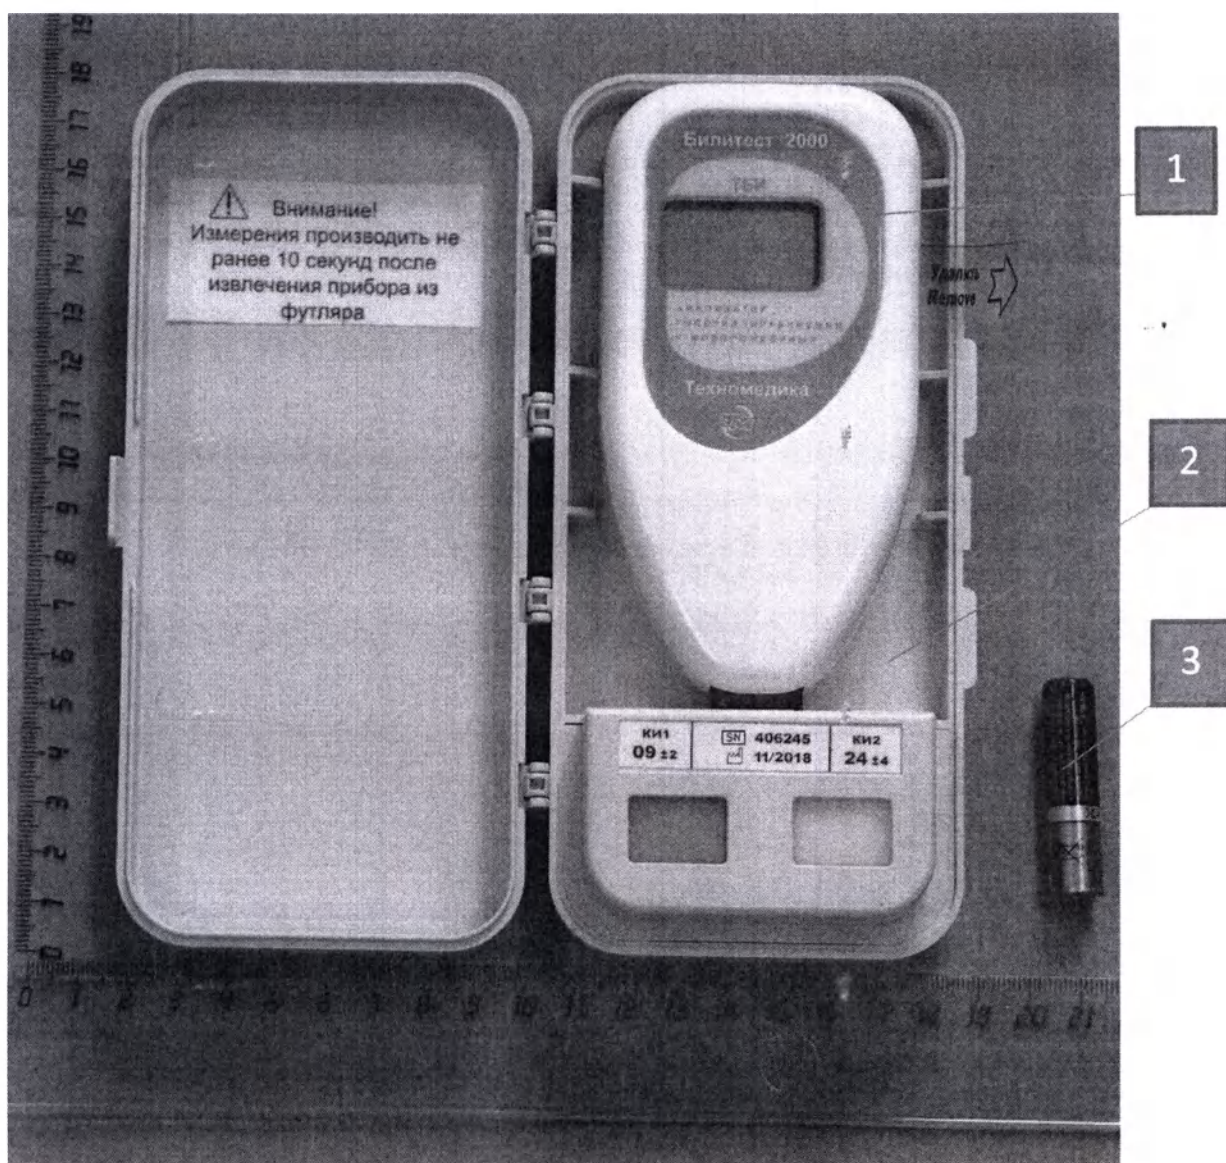


Фото 1

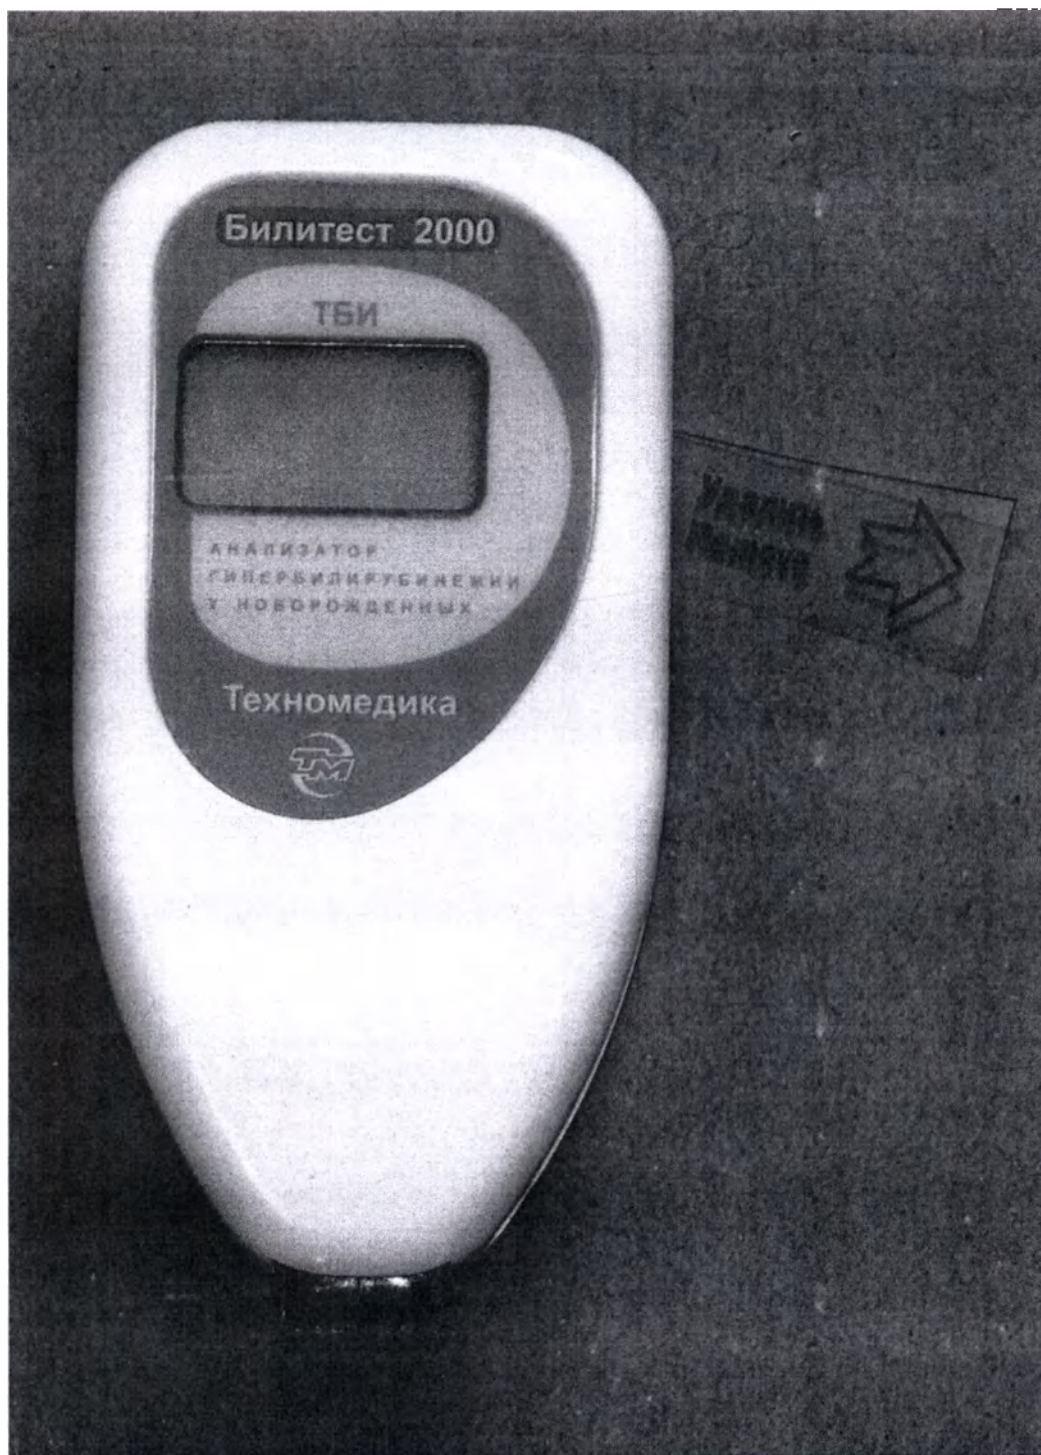


Фото 2

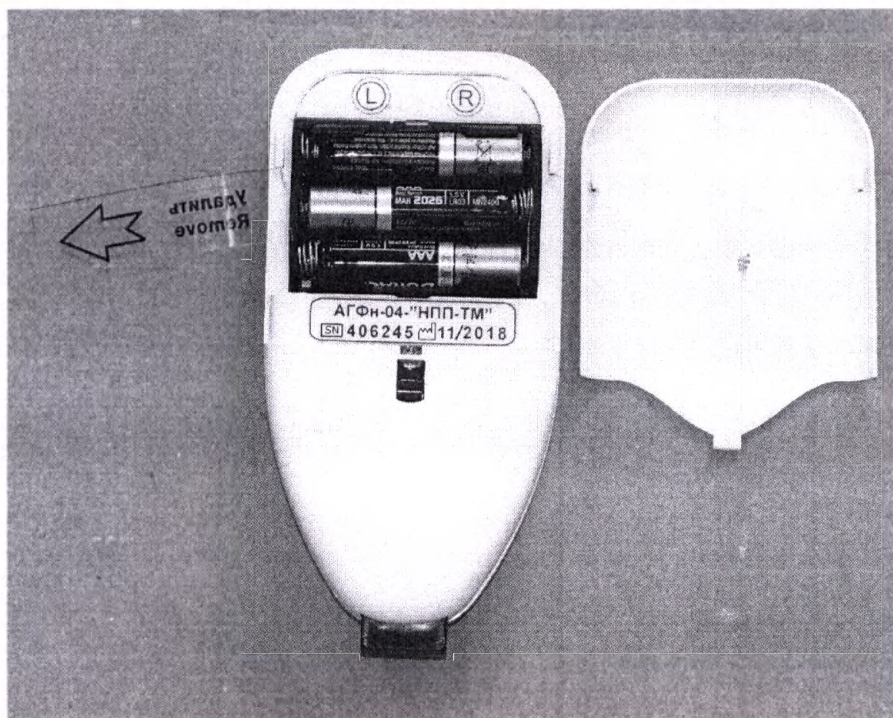


Фото 3

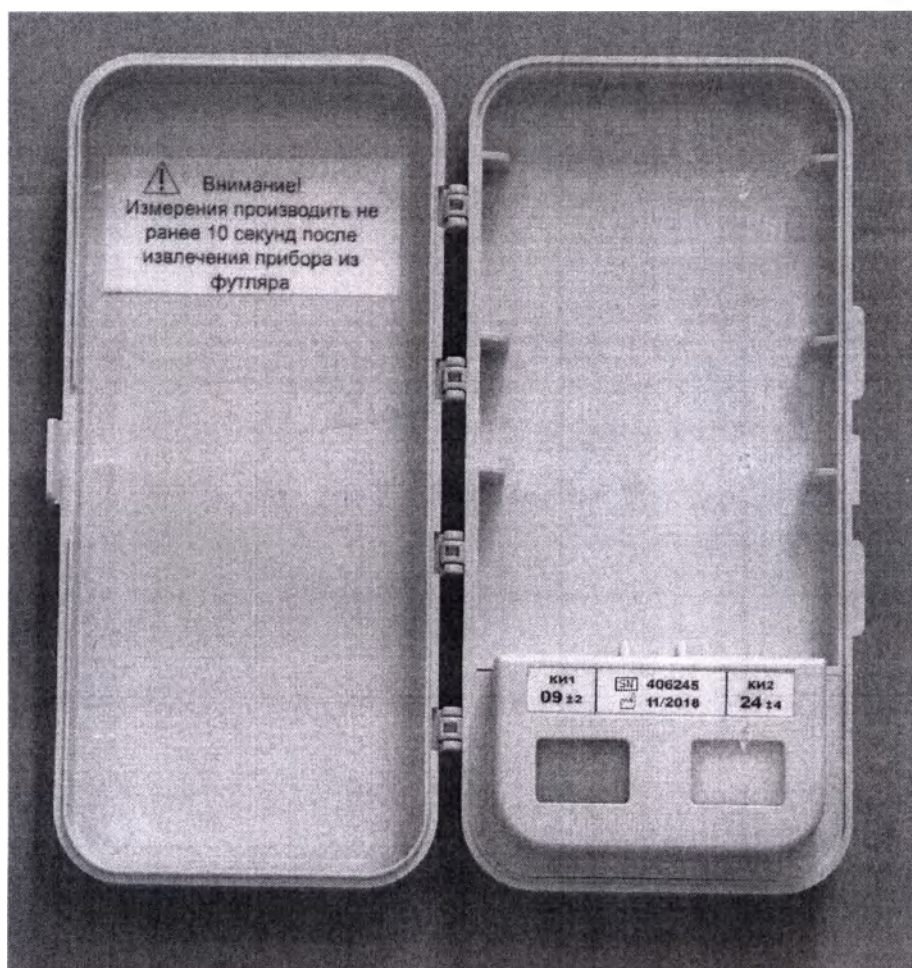


Фото 4

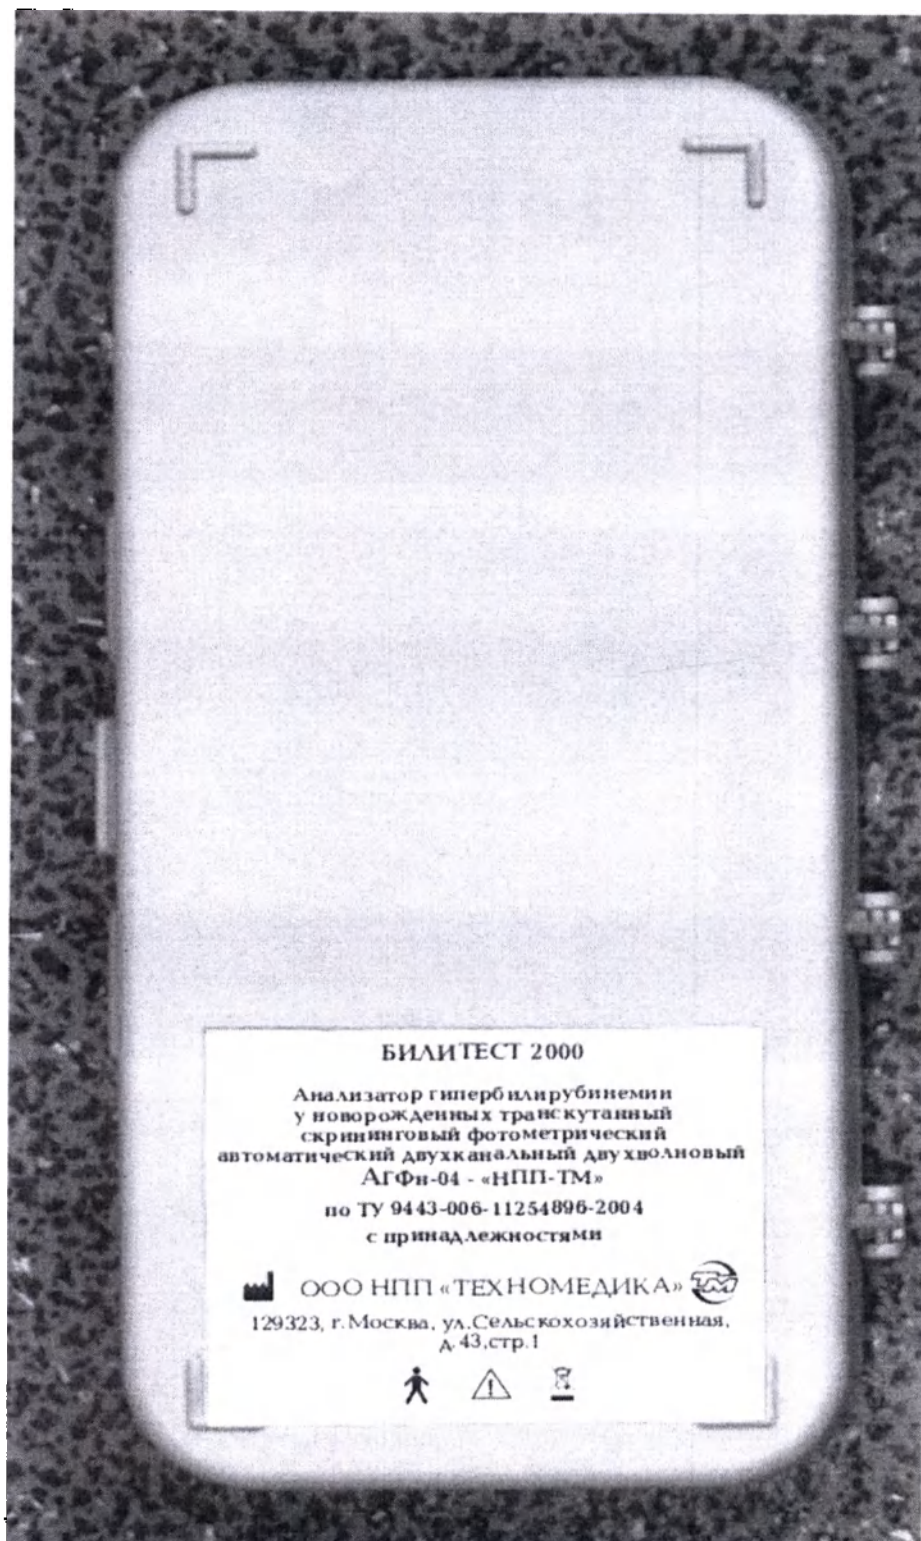


Фото 5

Прошито и скреплено печатью
5 (п. 2) листа(ов)

Генеральный директор
ООО НПП «ТЕХНОМЕДИКА»  Ованесов Н.Е.

