

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ООО «ИМБИАН ЛАБ»



Осипова В.В.\

2022 г.

«Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения in vitro раково-эмбрионального антигена в образцах сыворотки, плазмы или цельной крови человека «РЭА-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-146-41390295-2021, в исполнениях»

Макет маркировки

2022

Комплект 1

РЭА-ИМБИАН-ИХА

Флакон-капельница с буферным раствором - 3 мл

ГГГГ-ММ-ДД LOT XXXXXX

РЭА-ИМБИАН-ИХА

Комплект №1

Набор содержит:

1 Тест-кассета	1 шт	
2 Флакон-капельница с буферным раствором (3 мл)	1 шт	
3 Пипетка Пастера (0,25 мл) (РУ № РЗН 2019/8912)	1 шт	LOT XXXXXX
4 Скарификатор (РУ № ФСЗ 2011/09783)	1 шт	REF XX-XXX/X
5 Салфетка спиртовая для дезинфекции кожи (РУ № РЗН 2013/822)	1 шт	ГГГГ-ММ-ДД
6 Схема использования скарификатора	1 шт	ГГГГ-ММ-ДД
7 Инструкция по применению	1 шт	

Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения in vitro раково-эмбрионального антигена в образцах сыворотки, плазмы или цельной крови человека «РЭА-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-146-41390295-2021, в исполнении

РУ № XXX XXXX/XXXXX

Imbian

Готово к использованию
Только для диагностики in vitro. ТУ 21.20.23-146-41390295-2021
Для профессионального применения

IVD

30°C

630559 Новосибирская обл.
Г.О. Рабочий поселок Копыцово,
РП Копыцово, ул. Садовая, д. 2/7,
этаж 2, помещ. 2
8-800-600-90-77; info@imbian.ru

РЭА-ИМБИАН-ИХА

РУ № РЗН 2019/8912

Пипетка Пастера (0,25 мл) - 1 шт

ГГГГ-ММ-ДД LOT XXXXXX

ГГГГ-ММ-ДД

IVD

РЭА-ИМБИАН-ИХА

РУ № ФСЗ 2011/09783

Скарификатор - 1 шт

ГГГГ-ММ-ДД LOT XXXXXX

ГГГГ-ММ-ДД

IVD

РЭА-ИМБИАН-ИХА

Тест-кассета - 1 шт

ГГГГ-ММ-ДД LOT XXXXXX

ГГГГ-ММ-ДД

IVD

Комплект 2

РЭА-ИМБИАН-ИХА

Флакон-капельница с буферным раствором - 3 мл

ГГГГ-ММ-ДД LOT XXXXXX

РЭА-ИМБИАН-ИХА

Комплект №2

Набор содержит:

1 Тест-кассета	10 шт	
2 Флакон-капельница с буферным раствором (3 мл)	1 шт	
3 Пипетка Пастера (0,25 мл) (РУ № РЗН 2019/8912)	10 шт	LOT XXXXXX
4 Скарификатор (РУ № ФСЗ 2011/09783)	10 шт	REF XX-XXX/X
5 Салфетка спиртовая для дезинфекции кожи (РУ № РЗН 2013/822)	10 шт	ГГГГ-ММ-ДД
6 Схема использования скарификатора	1 шт	ГГГГ-ММ-ДД
7 Инструкция по применению	1 шт	

Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения in vitro раково-эмбрионального антигена в образцах сыворотки, плазмы или цельной крови человека «РЭА-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-146-41390295-2021, в исполнении

РУ № XXX XXXX/XXXXX

Imbian

Готово к использованию
Только для диагностики in vitro. ТУ 21.20.23-146-41390295-2021
Для профессионального применения

IVD

30°C

630559 Новосибирская обл.
Г.О. Рабочий поселок Копыцово,
РП Копыцово, ул. Садовая, д. 2/7,
этаж 2, помещ. 2
8-800-600-90-77; info@imbian.ru

РЭА-ИМБИАН-ИХА

РУ № РЗН 2019/8912

Пипетка Пастера (0,25 мл) - 10 шт

ГГГГ-ММ-ДД LOT XXXXXX

ГГГГ-ММ-ДД

IVD

РЭА-ИМБИАН-ИХА

РУ № ФСЗ 2011/09783

Скарификатор - 10 шт

ГГГГ-ММ-ДД LOT XXXXXX

ГГГГ-ММ-ДД

IVD

РЭА-ИМБИАН-ИХА

Тест-кассета - 1 шт

ГГГГ-ММ-ДД LOT XXXXXX

ГГГГ-ММ-ДД

IVD

Комплект 3

РЭА-ИМБИАН-ИХА ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Флакон-капельница с буферным раствором - 3 мл

ГГГГ-ММ-ДД LOT XXXXXX IVD

РЭА-ИМБИАН-ИХА

Комплект №3

Набор содержит:

1 Тест-кассета	30 шт	
2 Флакон-капельница с буферным раствором (3 мл)	2 шт	
3 Пипетка Пастера (0,25 мл) (ПУ № РЗН 2019/8912)	30 шт	LOT XXXXXX
4 Скарификатор (ПУ № ФСЗ 2011/09783)	30 шт	REF XX-XXX/X
5 Салфетка спиртовая для дезинфекции кожи (ПУ № РЗН 2013/822)	30 шт	ГГГГ-ММ-ДД
6 Схема использования скарификатора	1 шт	ГГГГ-ММ-ДД
7 Инструкция по применению	1 шт	

Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения in vitro раково-эмбрионального антигена в образцах сыворотки, плазмы или цельной крови человека «РЭА-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-146-41390295-2021, в исполнении

ПУ № XXX XXXX/XXXXX

Imbian

Готово к использованию
Только для диагностики in vitro. ТУ 21.20.23-146-41390295-2021
Для профессионального применения

IVD +2°C -30°C 30

ООО «ИМБИАН ЛАБ»
 630559, Новосибирская обл.
 Г.О. Рабочий поселок Кольцово
 РП Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7
 этаж 2, помещ. 2
 8-800-600-90-77, info@imbian.ru

Комплект 4

РЭА-ИМБИАН-ИХА ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Флакон-капельница с буферным раствором - 3 мл

ГГГГ-ММ-ДД LOT XXXXXX IVD

РЭА-ИМБИАН-ИХА ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Микропробирка (1,8 мл) - 25 шт

ГГГГ-ММ-ДД LOT XXXXXX IVD

РЭА-ИМБИАН-ИХА

Комплект №4

Набор содержит:

1 Тест-полоска	25 шт	
2 Флакон-капельница с буферным раствором (3 мл)	1 шт	
3 Пипетка Пастера (0,25 мл) (ПУ № РЗН 2019/8912)	25 шт	LOT XXXXXX
4 Скарификатор (ПУ № ФСЗ 2011/09783)	25 шт	REF XX-XXX/X
5 Микропробирка (1,8 мл)	25 шт	ГГГГ-ММ-ДД
6 Подставка под микропробирки	1 шт	ГГГГ-ММ-ДД
7 Салфетка спиртовая для дезинфекции кожи (ПУ № РЗН 2013/822)	25 шт	
8 Схема использования скарификатора	1 шт	
9 Инструкция по применению	1 шт	

Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения in vitro раково-эмбрионального антигена в образцах сыворотки, плазмы или цельной крови человека «РЭА-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-146-41390295-2021, в исполнении

ПУ № XXX XXXX/XXXXX

Imbian

Готово к использованию
Только для диагностики in vitro. ТУ 21.20.23-146-41390295-2021
Для профессионального применения

IVD +2°C -30°C 25

ООО «ИМБИАН ЛАБ»
 630559, Новосибирская обл.
 Г.О. Рабочий поселок Кольцово
 РП Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7
 этаж 2, помещ. 2
 8-800-600-90-77, info@imbian.ru

Комплект 5

РЭА-ИМБИАН-ИХА

Флакон-капельница с буферным раствором - 3 мл

ГГГГ-ММ-ДД LOT XXXXXX

РЭА-ИМБИАН-ИХА

Микропробирка (1,8 мл) - 50 шт

ГГГГ-ММ-ДД LOT XXXXXX

РЭА-ИМБИАН-ИХА

Комплект №5

Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения in vitro раково-эмбрионального антигена в образцах сыворотки, плазмы или цельной крови человека «РЭА-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-146-41390295-2021, в исполнении

Imbian

Набор содержит:

1 Тест-полоска 2 Флакон-капельница с буферным раствором (3 мл) 3 Пипетка Пастера (0,25 мл) (РУ № РЗН 2019/8912) 4 Скарификатор (РУ № ФСЗ 2011/09783) 5 Микропробирка (1,8 мл) 6 Подставка под микропробирки 7 Салфетка спиртовая для дезинфекции кожи (РУ № РЗН 2013/822) 8 Схема использования скарификатора 9 Инструкция по применению	50 шт (в тубе полимерной) 2 шт 50 шт 50 шт 50 шт 2 шт 50 шт 1 шт 1 шт
--	--

Готово к использованию

Только для диагностики in vitro. ТУ 21.20.23-146-41390295-2021

Для профессионального применения

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

630559, Новосибирская обл.

Г.О. Рабочий поселок Копыцово

РП Копыцово, ул. Садовая, д. 2/7

этаж 2, помещ. 2

8-800-600-90-77, info@imbian.ru

Комплект 6

РЭА-ИМБИАН-ИХА

Флакон-капельница с буферным раствором - 3 мл

ГГГГ-ММ-ДД LOT XXXXXX

РЭА-ИМБИАН-ИХА

Микропробирка (1,8 мл) - 100 шт

ГГГГ-ММ-ДД LOT XXXXXX

РЭА-ИМБИАН-ИХА

Комплект №6

Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения in vitro раково-эмбрионального антигена в образцах сыворотки, плазмы или цельной крови человека «РЭА-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-146-41390295-2021, в исполнении

Imbian

Набор содержит:

1 Тест-полоска 2 Флакон-капельница с буферным раствором (3 мл) 3 Пипетка Пастера (0,25 мл) (РУ № РЗН 2019/8912) 4 Скарификатор (РУ № ФСЗ 2011/09783) 5 Микропробирка (1,8 мл) 6 Подставка под микропробирки 7 Салфетка спиртовая для дезинфекции кожи (РУ № РЗН 2013/822) 8 Схема использования скарификатора 9 Инструкция по применению	100 шт (в тубе полимерной) 4 шт 100 шт 100 шт 100 шт 4 шт 100 шт 1 шт 1 шт
--	---

Готово к использованию

Только для диагностики in vitro. ТУ 21.20.23-146-41390295-2021

Для профессионального применения

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

630559, Новосибирская обл.

Г.О. Рабочий поселок Копыцово

РП Копыцово, ул. Садовая, д. 2/7

этаж 2, помещ. 2

8-800-600-90-77, info@imbian.ru

Транспортная упаковка

РЭА-ИМБИАН-ИХА		Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения <i>in vitro</i> раково-эмбионального антигена в образцах сыворотки, плазмы или цельной крови человека «РЭА-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-146-41390295-2021, в исполнениях	
РУ № XXX XXXX/XXXXX ТУ 21.20.23-146-41390295-2021		Масса нетто	кг
Количество наборов	шт	Масса брутто	кг
LOT XXXXXX	ГГГГ-ММ-ДД	Масса нетто потребительской упаковки	кг
REF XX-XXX/X	ГГГГ-ММ-ДД	IVD	
Замораживать не допускается Допускается транспортирование при температуре от 2 до 30°C			

Генеральный директор ООО «ИМБИАН ЛАБ»



В.В. Осипова

Сшито и заверено печатью 5
(1.9.16) лист 08

Генеральный директор ООО «Имбиан лаб»
Осипова В.В.



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Осипова В.В.

2022 г.



Фотографические изображения общего вида медицинского изделия вместе с принадлежностями, необходимыми для применения медицинского изделия по назначению


Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения in vitro раково-эмбрионального антигена в образцах сыворотки, плазмы или цельной крови человека «РЭА-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-146-41390295-2021, в исполнениях.

В состав наборов могут входить следующие компоненты:


Тест-кассета



Тест-полоска

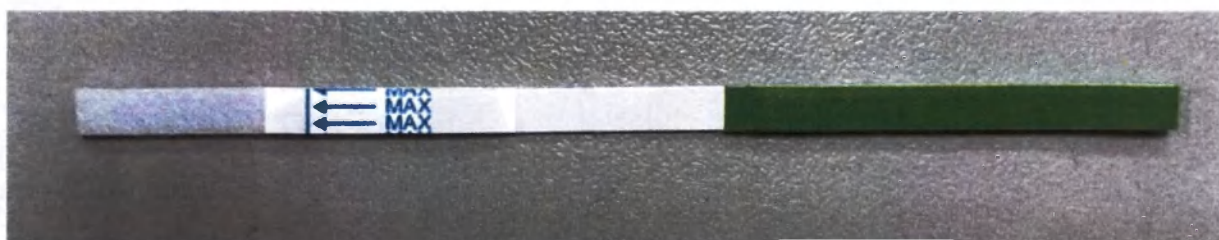

Пипетка Пастера (0,25 мл) (РУ № РЗН 2019/8912)

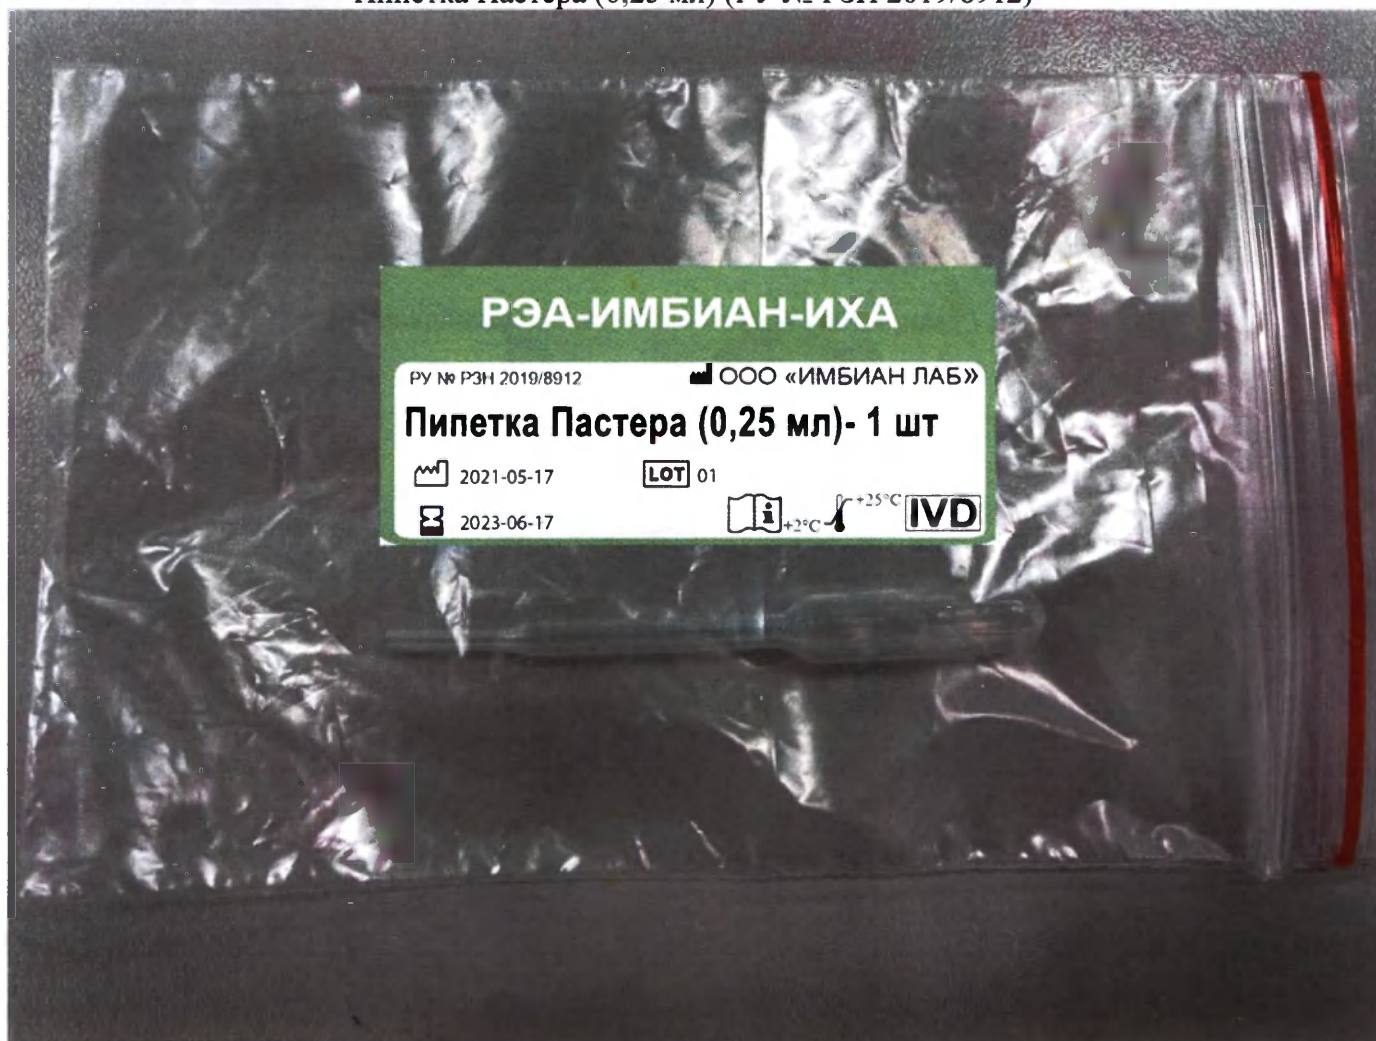


Микропробирка (1,8 мл)




Флакон-капельница с буферным раствором (3 мл)



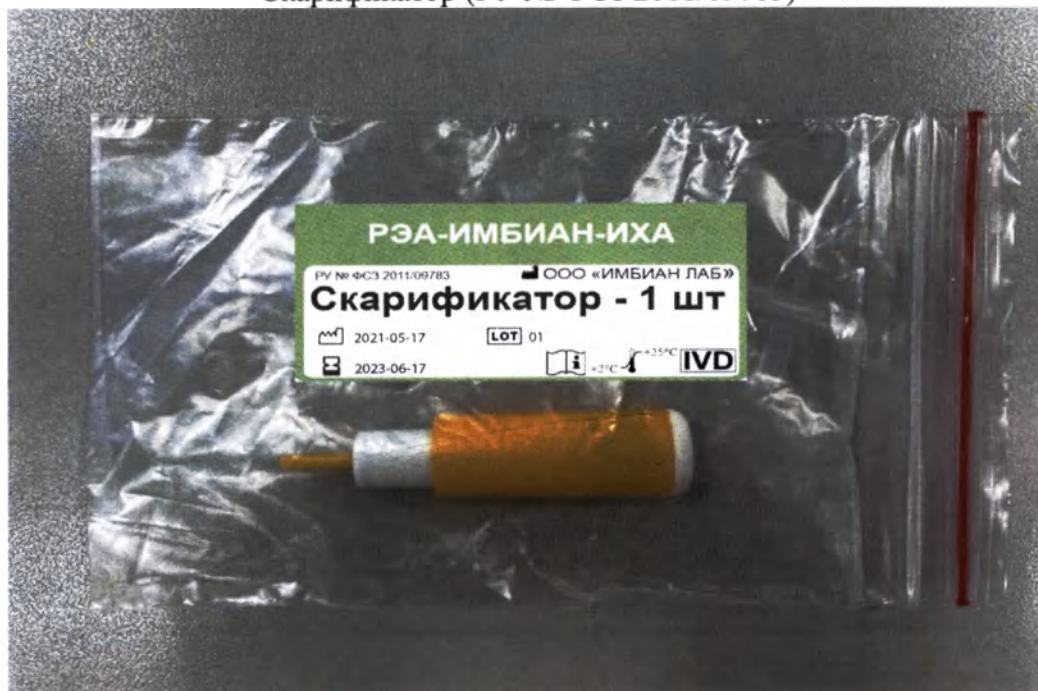

Подставка под микропробирки

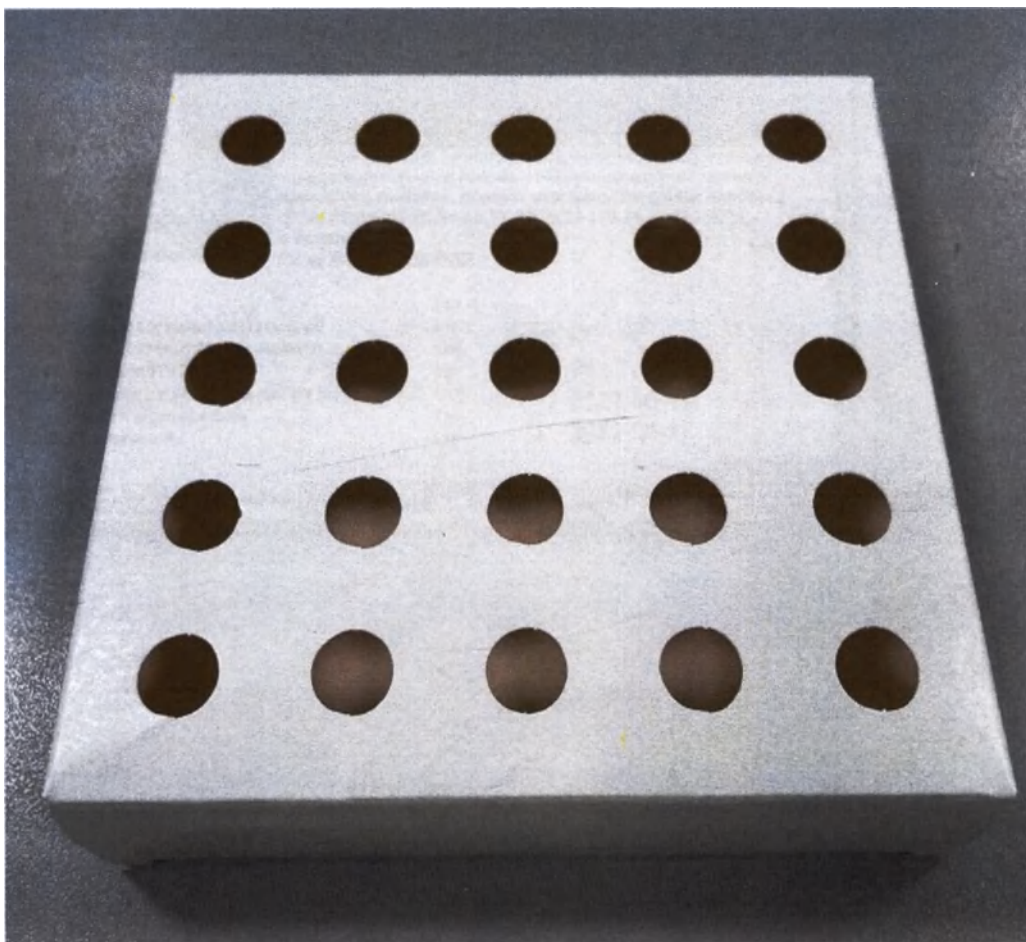

РЭА-ИМБИАН-ИХА

Комплект №1

Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения *in vitro* раково-эмбрионального антигена в образцах сыворотки, плазмы или цельной крови человека «РЭА-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-146-41390295-2021, в исполнении
РУ № XXX XXXX/XXXXX

Imbian

Набор содержит:

1 Тест-кассета	1 шт
2 Флакон-капельница с буферным раствором (3 мл)	1 шт
3 Пипетка Пастера (0,25 мл) (РУ № РЗН 2019/8912)	1 шт
4 Скарификатор (РУ № ФСЗ 2011/09783)	1 шт
5 Салфетка спиртовая для дезинфекции кожи (РУ № РЗН 2013/822)	1 шт
6 Схема использования скарификатора	1 шт
7 Инструкция по применению	1 шт

LOT 01

REF 01

2021-05-17

2023-06-17

Готово к использованию
Только для диагностики *in vitro*, ТУ 21.20.23-146-41390295-2021
Для профессионального применения

IVD

!

-2°C

50°C

i

V

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!


!

!

!

!

ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630509, Новосибирская обл.
Г.О. Рабочий поселок Колывань,
РП Колыванское ул. Савваева, д. 3/7
эт. 2, кабин. 2
8-800-609-80-77 info@imbiana.ru

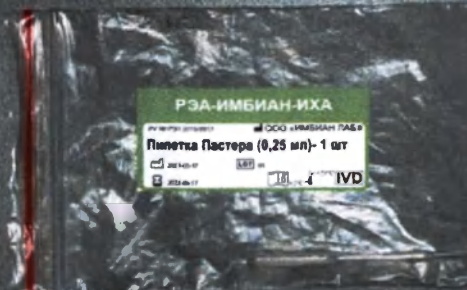

Imbian

ИНСТРУКЦИЯ по применению

«Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения *in vitro* раково-эмбрионального антигена в образцах сыворотки, плазмы или цельной крови человека «РЭА-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-146-41390295-2021, в исполнении



РЭА- ИМБИАН-ИХА

Комплект №1

Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения in vitro раково-эмбрионального антигена в образцах сыворотки, плазмы или цельной крови человека «РЭА-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-146-41390295-2021,

в исполнении
РУ № XXX XXXX/XXXXX



Набор содержит:

1 Тест-кассета	1 шт
2 Флакон-капельница с буферным раствором (3 мл)	1 шт
3 Пипетка Пастера (0,25 мл) (РУ № РЗН 2019/8912)	1 шт
4 Скарификатор (РУ № ФСЗ 2011/09783)	1 шт
5 Салфетка спиртовая для дезинфекции кожи (РУ № РЗН 2013/822)	1 шт
6 Схема использования скарификатора	1 шт
7 Инструкция по применению	1 шт


LOT 01

REF 01


2021-05-17

2023-06-17

Готово к использованию
Только для диагностики in vitro. ТУ 21.20.23-146-41390295-2021
Для профессионального применения



ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Новосибирская обл.
Г.О. Рабочий поселок Кольцово,
РП Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7,
этаж 2, помещ. 2
8-800-600-90-77; info@imbian.ru

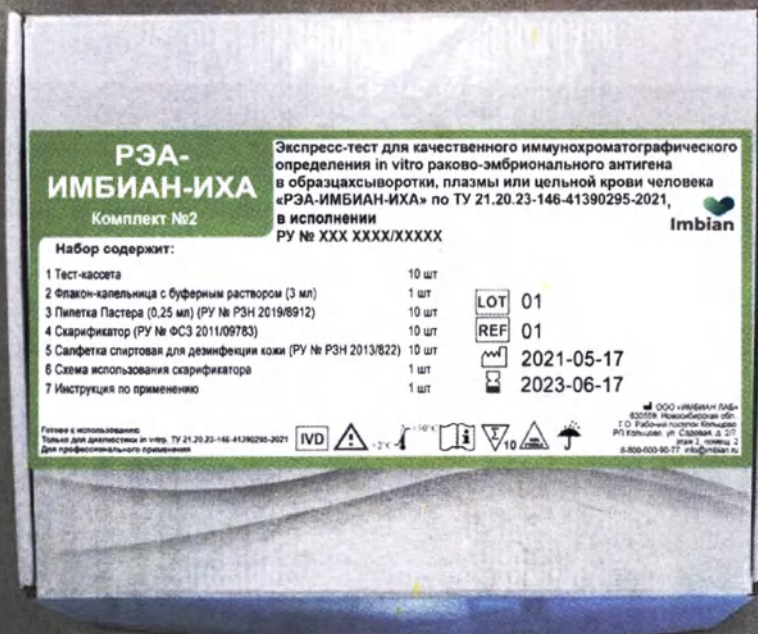

РЭА- ИМБИАН-ИХА

Комплект №2

Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения *in vitro* раково-эмбрионального антигена в образцах сыворотки, плазмы или цельной крови человека «РЭА-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-146-41390295-2021, в исполнении
РУ № XXX XXXX/XXXXXX



Набор содержит:

1 Тест-кассета	10 шт
2 Флакон-капельница с буферным раствором (3 мл)	1 шт
3 Пипетка Пастера (0,25 мл) (РУ № РЗН 2019/8912)	10 шт
4 Скарификатор (РУ № ФСЗ 2011/09783)	10 шт
5 Салфетка спиртовая для дезинфекции кожи (РУ № РЗН 2013/822)	10 шт
6 Схема использования скарификатора	1 шт
7 Инструкция по применению	1 шт

LOT 01

REF 01


2021-05-17

2023-06-17

Готово к использованию
Только для диагностики *in vitro*. ТУ 21.20.23-146-41390295-2021
Для профессионального применения



ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Новосибирская обл.
Г.О. Рабочий поселок Копыцово
РП Копыцово, ул. Садовая, д. 2/7,
этаж 2, помещ. 2
8-800-600-90-77, info@imbian.ru

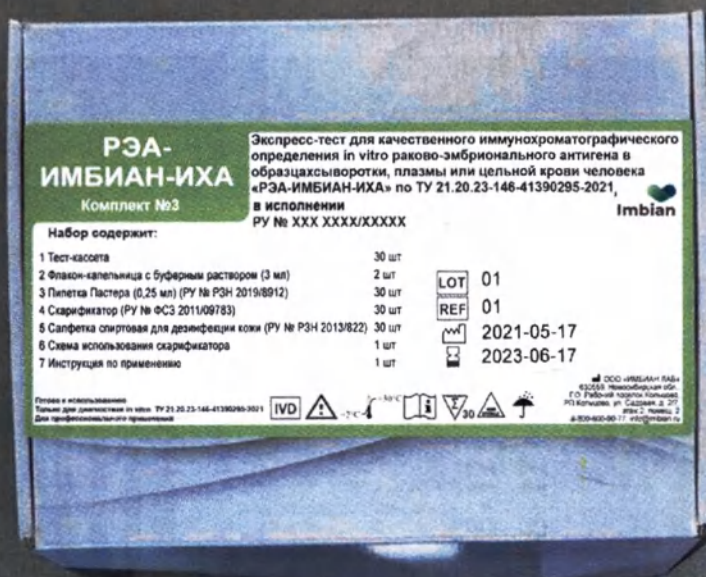

РЭА- ИМБИАН-ИХА

Комплект №3

Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения *in vitro* раково-эмбрионального антигена в образцах сыворотки, плазмы или цельной крови человека «РЭА-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-146-41390295-2021,

в исполнении
РУ № XXX XXXX/XXXXX



Набор содержит:

1 Тест-кассета	30 шт
2 Флакон-капельница с буферным раствором (3 мл)	2 шт
3 Пипетка Пастера (0,25 мл) (РУ № РЗН 2019/8912)	30 шт
4 Скарifikатор (РУ № ФСЗ 2011/09783)	30 шт
5 Салфетка спиртовая для дезинфекции кожи (РУ № РЗН 2013/822)	30 шт
6 Схема использования скарifikатора	1 шт
7 Инструкция по применению	1 шт

LOT 01

REF 01

2021-05-17

2023-06-17

Готово к использованию
Только для диагностики *in vitro*. ТУ 21.20.23-146-41390295-2021
Для профессионального применения



+2°C

+30°C



30



ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Новосибирская обл.
Г.О. Рабочий поселок Кольцово
РП Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7,
этаж 2, помещ. 2
8-800-600-90-77, info@imbian.ru



РЭА- ИМБИАН-ИХА

Комплект №4

Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения in vitro раково-эмбрионального антигена в образцах сыворотки, плазмы или цельной крови человека «РЭА-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-146-41390295-2021, в исполнении
РУ № XXX XXXX/XXXXX



Набор содержит:

1 Тест-полоска	25 шт
2 Флакон-капельница с буферным раствором (3 мл)	1 шт
3 Пипетка Пастера (0,25 мл) (РУ № РЗН 2019/8912)	25 шт
4 Скарификатор (РУ № ФСЗ 2011/09783)	25 шт
5 Микропробирка (1,8 мл)	25 шт
6 Подставка под микропробирки	1 шт
7 Салфетка спиртовая для дезинфекции кожи (РУ № РЗН 2013/822)	25 шт
8 Схема использования скарификатора	1 шт
9 Инструкция по применению	1 шт

LOT 01

REF 01

2021-05-17

2023-06-17

Готово к использованию
Только для диагностики in vitro. ТУ 21.20.23-146-41390295-2021
Для профессионального применения



ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Новосибирская обл.,
Г.О. Рабочий поселок Кольцово,
РП Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7,
этаж 2, помещ. 2
8-800-800-90-77, info@imbian.ru

РЭА-ИМБИАН-ИХА

Комплект №5


Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения in vitro раково-эмбрионального антигена в образцах сыворотки, плазмы или цельной крови человека «РЭА-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-146-41390295-2021, в исполнении

Imbian



Набор содержит:

- | | | |
|---|---------------------------|------------|
| 1 Тест-полоска | 50 шт (в тубе полимерной) | |
| 2 Флакон-капельница с буферным раствором (3 мл) | 2 шт | |
| 3 Пилетка Пастера (0,25 мл) (РУ № РЗН 2019/8912) | 50 шт | LOT 01 |
| 4 Скарификатор (РУ № ФСЗ 2011/09783) | 50 шт | REF 01 |
| 5 Микропробирка (1,8 мл) | 50 шт | |
| 6 Подставка под микропробирки | 2 шт | |
| 7 Салфетка спиртовая для дезинфекции кожи (РУ № РЗН 2013/822) | 50 шт | 2021-05-17 |
| 8 Схема использования скарификатора | 1 шт | 2023-06-17 |
| 9 Инструкция по применению | 1 шт | |

Готово к использованию
Только для диагностики in vitro. ТУ 21.20.23-146-41390295-2021
Для профессионального применения



ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630550, Новосибирская обл.
Г.О. Рыбинский район, Еленинское
РП Колыбель: ул. Садовая, д. 27,
эт. 2, комн. 3
8-800-400-90-77, info@imbian.ru

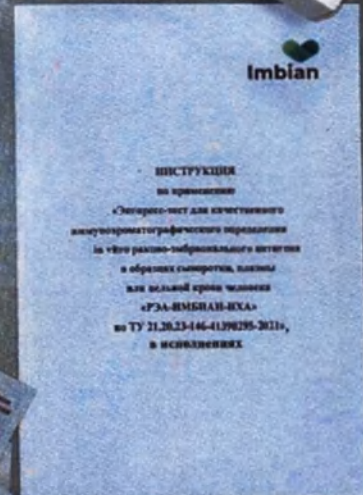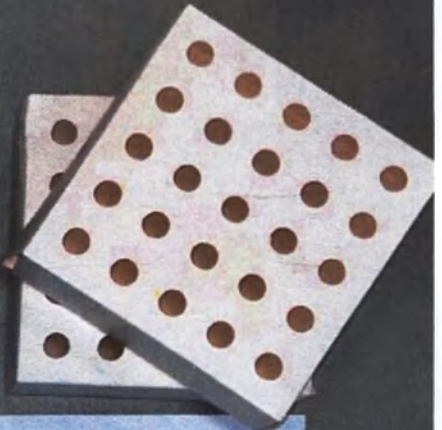

РЭА- ИМБИАН-ИХА

Комплект №5

Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения *in vitro* раково-эмбрионального антигена в образцах сыворотки, плазмы или цельной крови человека «РЭА-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-146-41390295-2021, в исполнении
РУ № XXX XXXX/XXXXX



Набор содержит:

1 Тест-полоска	50 шт (в тубе полимерной)
2 Флакон-капельница с буферным раствором (3 мл)	2 шт
3 Пипетка Пастера (0,25 мл) (РУ № РЗН 2019/8912)	50 шт
4 Скарификатор (РУ № ФСЗ 2011/09783)	50 шт
5 Микропробирка (1,8 мл)	50 шт
6 Подставка под микропробирки	2 шт
7 Салфетка спиртовая для дезинфекции кожи (РУ № РЗН 2013/822)	50 шт
8 Схема использования скарификатора	1 шт
9 Инструкция по применению	1 шт

LOT 01

REF 01

2021-05-17

2023-06-17

Готово к использованию
Только для диагностики *in vitro*. ТУ 21.20.23-146-41390295-2021
Для профессионального применения



ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Новосибирская обл.,
Г.О. Рабочий поселок Кольцово,
РП Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7,
этаж 2, помещ. 2
8-800-600-90-77: info@imbian.ru

РЭА-ИМБИАН-ИХА

Комплект №6

Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения in vitro раково-эмбрионального антигена в образцах сыворотки, плазмы или цельной крови человека «РЭА-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-146-41390295-2021, в исполнении

Imbian

Набор содержит:

- 1 Тест-полоска
- 2 Флакон-капельница с буферным раствором (3 мл)
- 3 Пипетка Пастера (0,25 мл) (РУ № РЗН 2019/8912)
- 4 Скарификатор (РУ № ФСЗ 2011/09783)
- 5 Микропипетка (1,8 мл)
- 6 Подставка под микропипетки
- 7 Салфетка спиртовая для дезинфекции кожи (РУ № РЗН 2013/822)
- 8 Схема использования скарификатора
- 9 Инструкция по применению

100 шт (в тубе полимерной)

4 шт

100 шт

100 шт

100 шт

4 шт

100 шт

1 шт

1 шт

LOT 01

REF 01

2021-05-17

2023-06-17

Готово к использованию
Только для амбулаторного и стационарного использования
Для профессионального применения

IVD

-20°C

100

IVD

IVD

IVD

IVD

IVD

IVD

IVD

IVD

IVD

IVD

IVD

IVD

IVD

IVD

IVD

IVD

IVD

IVD

IVD

IVD

IVD


IVD

IVD

IVD

IVD

IVD

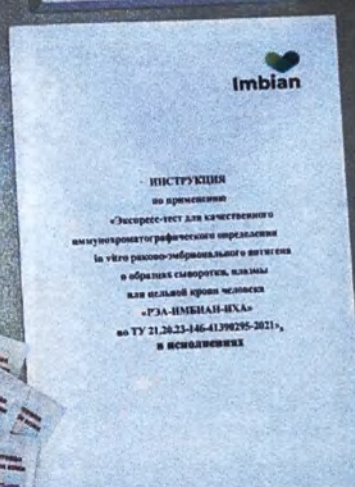

РЭА- ИМБИАН-ИХА

Комплект №6

Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения in vitro раково-эмбрионального антигена в образцах сыворотки, плазмы или цельной крови человека «РЭА-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-146-41390295-2021, в исполнении
РУ № XXX XXXX/XXXXX



Набор содержит:

1 Тест-полоска	100 шт (в тубе полимерной)
2 Флакон-капельница с буферным раствором (3 мл)	4 шт
3 Пипетка Пастера (0,25 мл) (РУ № РЗН 2019/8912)	100 шт
4 Скарификатор (РУ № ФСЗ 2011/09783)	100 шт
5 Микропробирка (1,8 мл)	100 шт
6 Подставка под микропробирки	4 шт
7 Салфетка спиртовая для дезинфекции кожи (РУ № РЗН 2013/822)	100 шт
8 Схема использования скарификатора	1 шт
9 Инструкция по применению	1 шт

LOT 01

REF 01

2021-05-17

2023-06-17

Готово к использованию
Только для диагностики in vitro. ТУ 21.20.23-146-41390295-2021
Для профессионального применения



+2°C



+30°C



Σ 100



ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Новосибирская обл.
Г.О. Рабочий поселок Кольцово,
РП Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7
этаж 2, помещ. 2
8-800-600-90-77; info@imbian.ru



Генеральный директор ООО «ИМБИАН ЛАБ»



В.В. Осипова

Сшито и заверено печатью 18
Восемьдесят) лист 08

Генеральный директор ООО «Имбиан лаб»
Осипова В.В.

