

Фотографические изображения медицинского изделия для диагностики in vitro

Набор реагентов «Экспресс-тест для качественного определения антигена SARS-CoV-2 иммунохроматографическим методом в образцах из респираторного тракта человека «C-test Ag Covid-19 (SARS-CoV-2)» по ТУ 21.20.23-001-46753495-2022, Lot № 01, 02»

C-test



20.03.2024



21.03.2022



LOT 01

C-test

Ag Covid-19 (SARS-CoV-2)

Набор реагентов «Экспресс-тест для
качественного определения антигена
SARS-CoV-2 иммунохроматографическим
методом в образцах из респираторного
тракта человека «C-test Ag Covid-19
(SARS-CoV-2)» по ТУ 21.20.23-001-46753495-2022,
Lot № 01, 02»

1 шт





Не использовать
по истечении срока годности

REF AGCOV-19-1

Комплект №1 (рассчитан на исследование
1 образца)

Состав набора:

- Тест-картридж (в индивидуальной
упаковке из фольги в комплекте с
осушителем) 1 шт.
- Пластиковая пробирка с насадкой -
капельницей с буферным раствором, 1 шт.
0,3 мл
- Зонд медицинский одноразовый
стерильный по ТУ 32.50.13-002-28731857-2020
производства ООО "ФармМедПолис РТ", 1 шт.
Россия (РУ РЗН № 2021/13989 от 26.11.2021)
- Инструкция по применению 1 шт.



ООО «КОНТРОЛЬНЫЙ ТЕСТ»

454016, ОБЛ. ЧЕЛЯБИНСКАЯ,
Г.О. ЧЕЛЯБИНСКИЙ, ВН. Р.-Н
КАЛИНИНСКИЙ, Г. ЧЕЛЯБИНСК,
УЛ. БРАТЬЕВ КАШИРИНЫХ, ДОМ 85Б,
ЭТАЖ 1, ПОМЕЩ. 6

тел./факс: +7 351 230-03-88

сайт: www.c-test.ru

e-mail: info@c-test.ru

ТУ 21.20.23-001-46753495-2022

РУ № РЗН ХХХХ/ХХХХХ

Только для диагностики in vitro

Для профессионального применения



210000001000015114



ВНИМАНИЕ!
Данный тест-картридж предназначен для выявления антител к SARS-CoV-2 в образцах биологического материала (слюна, кровь) с помощью метода иммунохроматографии. Тест-картридж не предназначен для диагностики COVID-19.

1. Область применения:
Тест-картридж предназначен для выявления антител к SARS-CoV-2 в образцах биологического материала (слюна, кровь) с помощью метода иммунохроматографии. Тест-картридж не предназначен для диагностики COVID-19.

2. Принцип действия:
Тест-картридж работает по принципу иммунохроматографии. В тест-картридже содержится две тест-полоски. Первая тест-полоска предназначена для выявления антител к SARS-CoV-2 в образцах биологического материала (слюна, кровь). Вторая тест-полоска предназначена для выявления антител к SARS-CoV-2 в образцах биологического материала (слюна, кровь).

3. Методика применения:
Тест-картридж применяется следующим образом: 1. Вставить тест-картридж в тест-систему. 2. Добавить в тест-систему образец биологического материала (слюна, кровь). 3. Подождать 10-15 минут. 4. Результат теста будет виден на тест-полосках.

4. Результаты теста:
Результат теста будет виден на тест-полосках. Если на тест-полоске появится красная линия, это означает положительный результат теста. Если на тест-полоске не появится красная линия, это означает отрицательный результат теста.

5. Срок годности:
Срок годности тест-картриджа составляет 12 месяцев со дня изготовления.

6. Условия хранения:
Тест-картридж должен храниться в сухом, защищенном от света месте при температуре от +2 до +25 °C.

7. Производитель:
Тест-картридж произведен в России.

8. Контактная информация:
Для получения дополнительной информации обращайтесь к производителю.





Дата изготовления: 21.03.2022
Годен до: 20.03.2024





Не использовать
по истечении срока годности

REF AGCOV-19-2

Комплект №2 (рассчитан на исследование
2 образцов)

Состав набора:

- Тест-картридж (в индивидуальной
упаковке из фольги в комплекте с
осушителем) 2 шт.
- Пластиковая пробирка с насадкой -
капельницей с буферным раствором,
0,3 мл 2 шт.
- Зонд медицинский одноразовый
стерильный по ТУ 32.50.13-002-28731857-2020
производства ООО "ФармМедПолис РТ", 2 шт.
Россия (РУ РЗН № 2021/13989 от 26.11.2021)
- Инструкция по применению 1 шт.



ООО «КОНТРОЛЬНЫЙ ТЕСТ»

454016, ОБЛ. ЧЕЛЯБИНСКАЯ,
Г.О. ЧЕЛЯБИНСКИЙ, ВН. Р.-Н
КАЛИНИНСКИЙ, Г.ЧЕЛЯБИНСК,
УЛ. БРАТЬЕВ КАШИРИНЫХ, ДОМ 85Б,
ЭТАЖ 1, ПОМЕЩ. 6

тел./факс: +7 351 230-03-88

сайт: www.c-test.ru


e-mail: info@c-test.ru

ТУ 21.20.23-001-46753495-2022

РУ № РЗН XXXX/XXXXX

Только для диагностики in vitro
Для профессионального применения



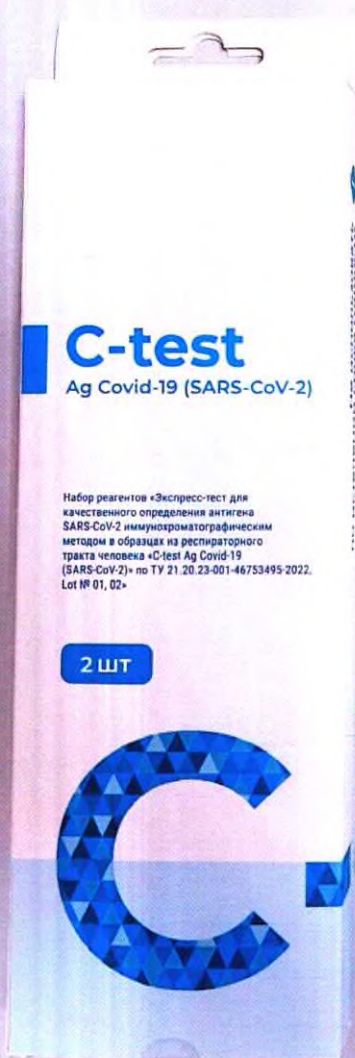


C-test

Ag Covid-19 (SARS-CoV-2)

Набор реагентов «Экспресс-тест для качественного определения антигена SARS-CoV-2 иммунохроматографическим методом в образцах из респираторного тракта человека «C-test Ag Covid-19 (SARS-CoV-2)» по ТУ 21.20.23-001-46753495-2022. Lot № 01, 02»

2 ШТ

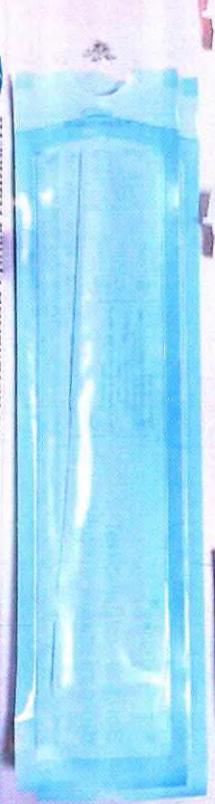

C-test

ИНСТРУКЦИЯ по применению медицинского изделия для диагностики in vitro

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ООО «ЦИРМИ»

1. Назначение медицинского изделия

2. Описание медицинского изделия

3. Область применения

4. Состав

5. Срок годности

6. Условия хранения

7. Меры безопасности

8. Контактная информация

9. Дата изготовления

10. Дата окончания срока годности

11. Дата вступления в силу

12. Дата отмены

13. Дата отзыва

14. Дата отмены отзыва

C-test

Ag Covid-19 (SARS-CoV-2)

1 ШТ

20.03.2024

1 ШТ

1 ШТ

1 ШТ

1 ШТ

1 ШТ

1 ШТ

1 ШТ

1 ШТ

1 ШТ

1 ШТ

1 ШТ

1 ШТ

1 ШТ

1 ШТ

1 ШТ

1 ШТ

1 ШТ

1 ШТ

1 ШТ

1 ШТ

1 ШТ

1 ШТ


1 ШТ

1 ШТ

1 ШТ

1 ШТ



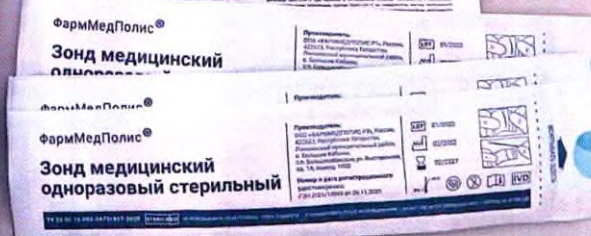

Не использовать
по истечении срока годности



REF AGCOV-19-3

Комплект № 3 (рассчитан на исследование 5 образцов)

Состав набора:

- Тест-картридж (в индивидуальной упаковке из фольги в комплекте с осушителем) 5 шт.
- Пластиковая пробирка с насадкой-капельницей с буферным раствором, 0,3 мл 5 шт.
- Зонд медицинский одноразовый стерильный по ТУ 32.50.13-002-28731857-2020
производства ООО "ФармМедПолис РТ", Россия (РУ РЗН № 2021/13989 от 26.11.2021) 5 шт.
- Инструкция по применению 1 шт.

LOT 01



21.03.2022



20.03.2024



ООО «КОНТРОЛЬНЫЙ ТЕСТ»

454016, ОБЛ. ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г. О. ЧЕЛЯБИНСКИЙ,
ВН. Р-Н КАЛИНИНСКИЙ, Г. ЧЕЛЯБИНСК,
УЛ. БРАТЬЕВ КАШИРИНЫХ, ДОМ 85Б, ЭТАЖ 1, ПОМЕЩ. 6,

тел./факс: +7 351 238-84-40,

сайт: www.c-test.ru, e-mail: info@c-test.ru

ТУ 21.20.23-001-46753495-2022
РУ № РЗН XXXX/XXXXX

Только для диагностики in vitro
Для профессионального применения




C-test

Ag Covid-19 (SARS-CoV-2)

Набор реагентов «Экспресс-тест для
качественного определения антигена SARS-CoV-2
иммунохроматографическим методом в образцах
из респираторного тракта человека «C-test Ag Covid-19
(SARS-CoV-2)» по ТУ 21.20.23-001-46753495-2022,
Lot № 01, 02»

25 ШТ

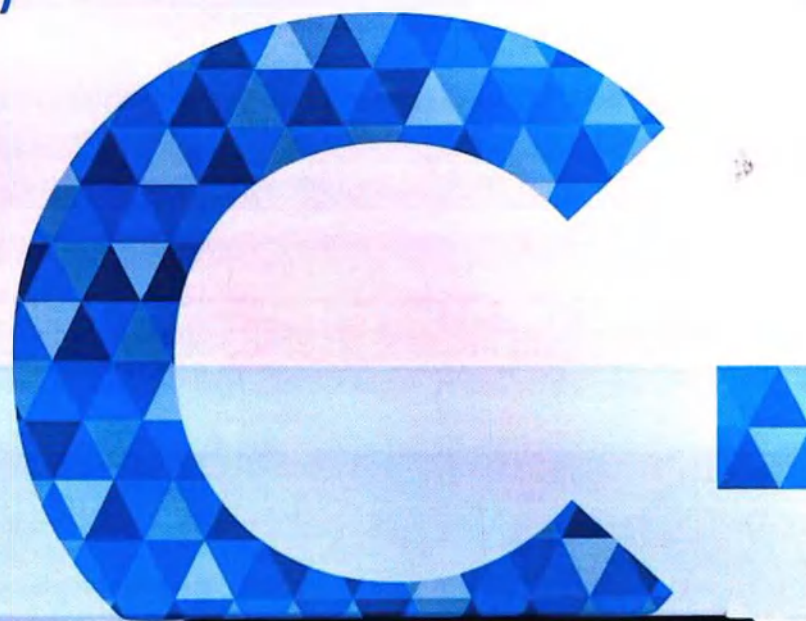








REF AGCOV-19-4

Комплект № 4 (рассчитан на исследование 25 образцов)

Состав набора:

Тест-картридж (в индивидуальной упаковке из фольги в комплекте с осушителем)	25 шт.
Флакон-капельница с буферным раствором, 5 мл	2 шт.
Пластиковая пробирка	25 шт.
Пластиковая пипетка типа Пастера	25 шт.
Зонд медицинский одноразовый стерильный по ТУ 32.50.13-002-28731857-2020 производства ООО "ФармМедПолис РТ", Россия (РУ РЗН № 2021/13989 от 26.11.2021)	25 шт.
Инструкция по применению	1 шт.

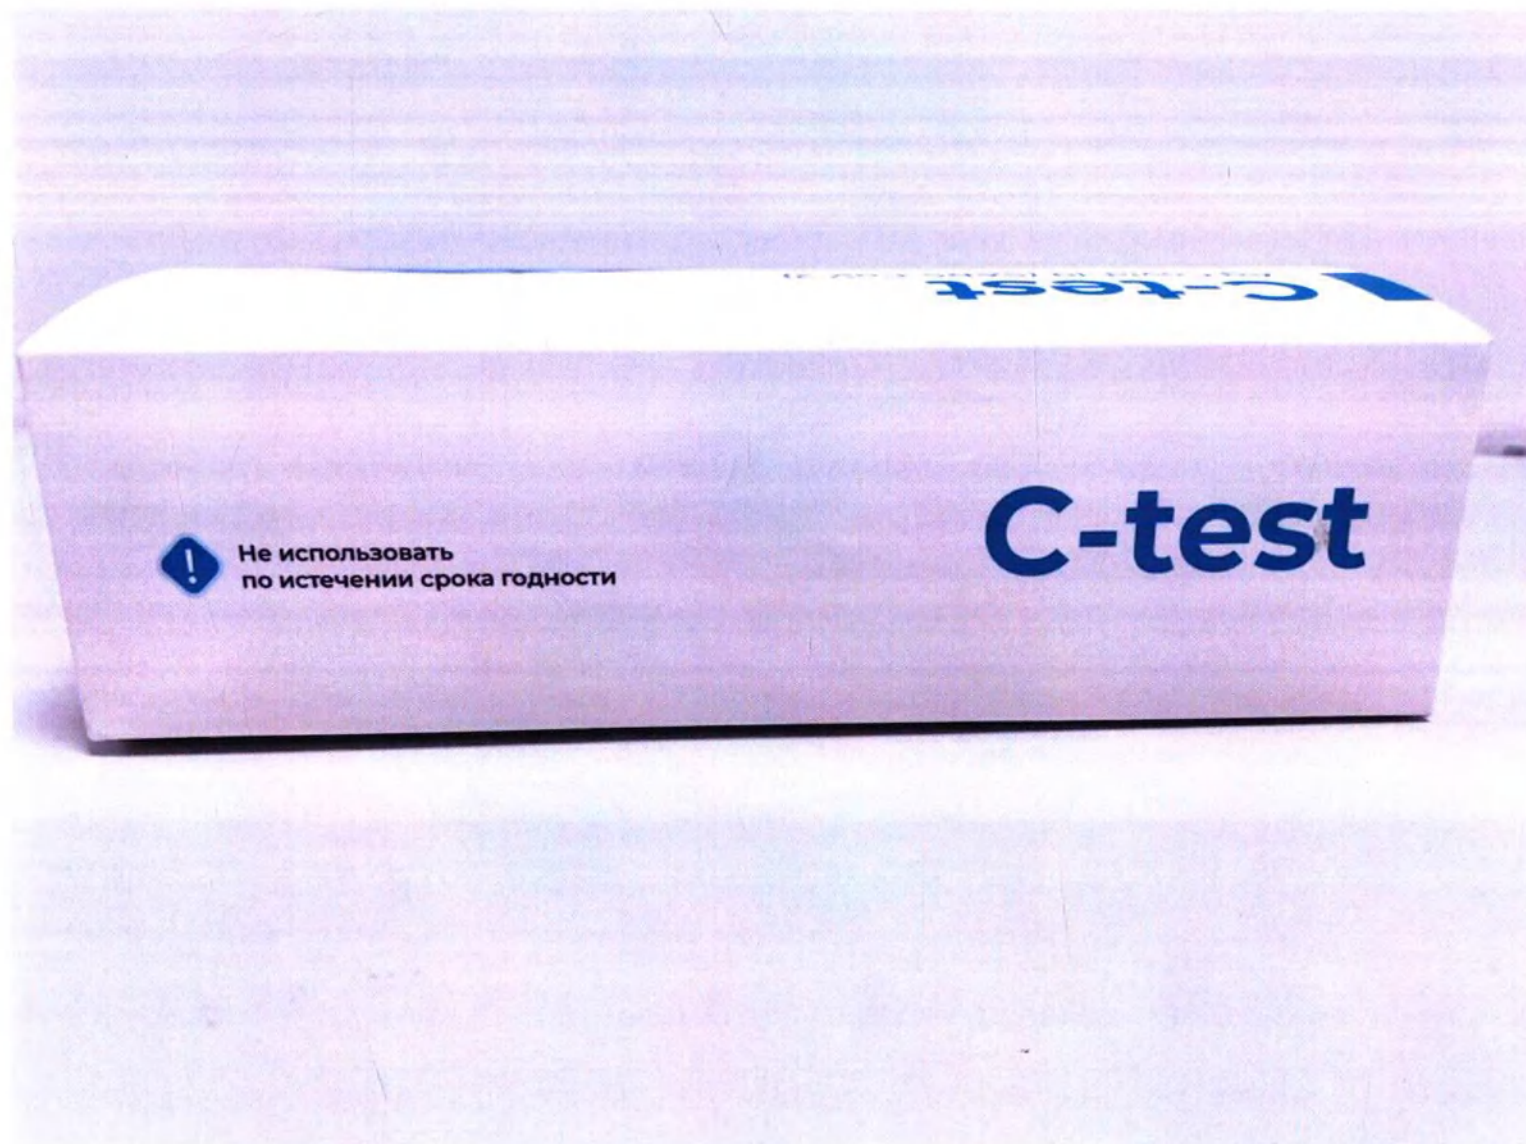




C-test

Ag Covid-19 (SARS-CoV-2)

Набор реагентов «Экспресс-тест для
качественного определения антигена SARS-CoV-2
иммунохроматографическим методом в образцах
из респираторного тракта человека «C-test Ag Covid-19
(SARS-CoV-2)» по ТУ 21.20.23-001-46753495-2022,
Lot № 01, 02»

25 шт

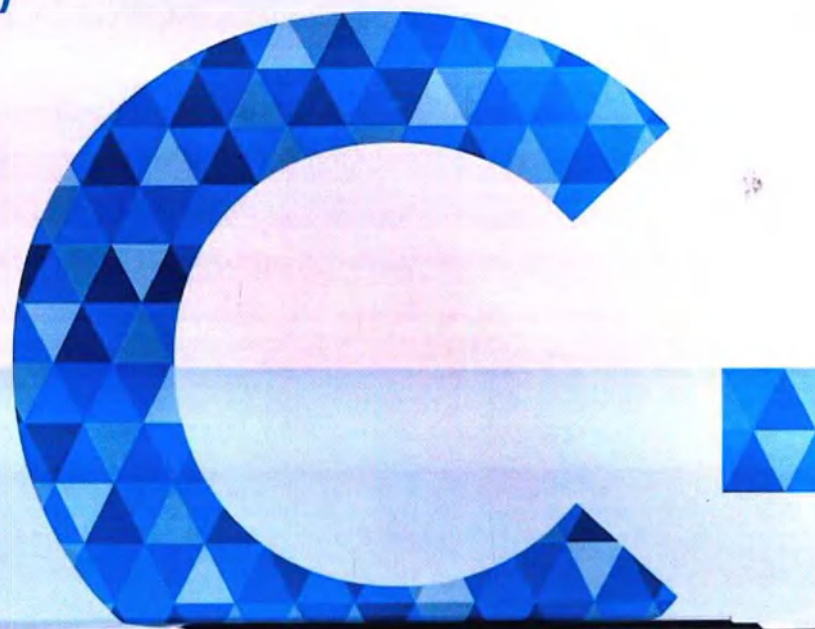






C-test

Ag Covid-19 (SARS-CoV-2)


Набор реагентов «Экспресс-тест для
качественного определения антигена SARS-CoV-2
иммунохроматографическим методом в образцах
из респираторного тракта человека «C-test Ag Covid-19
(SARS-CoV-2)» по ТУ 21.20.23-001-46753495-2022,
Lot № 01, 02»

25 ШТ

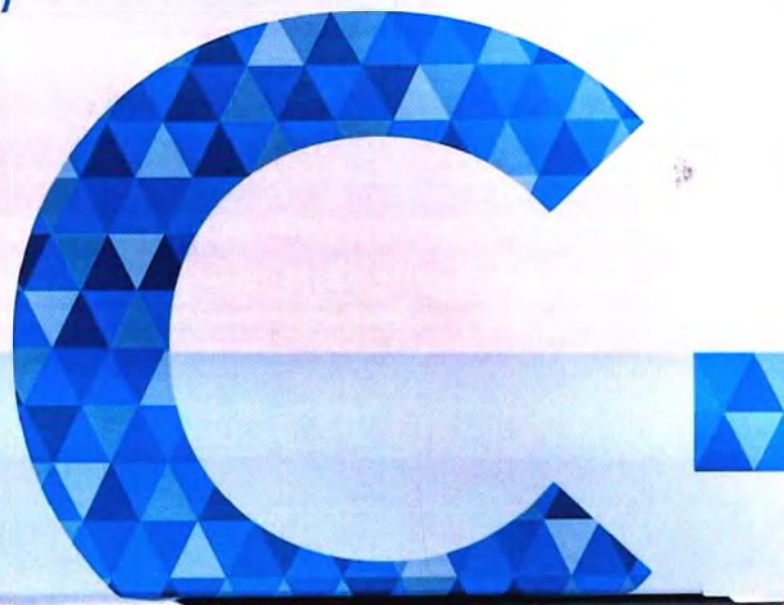





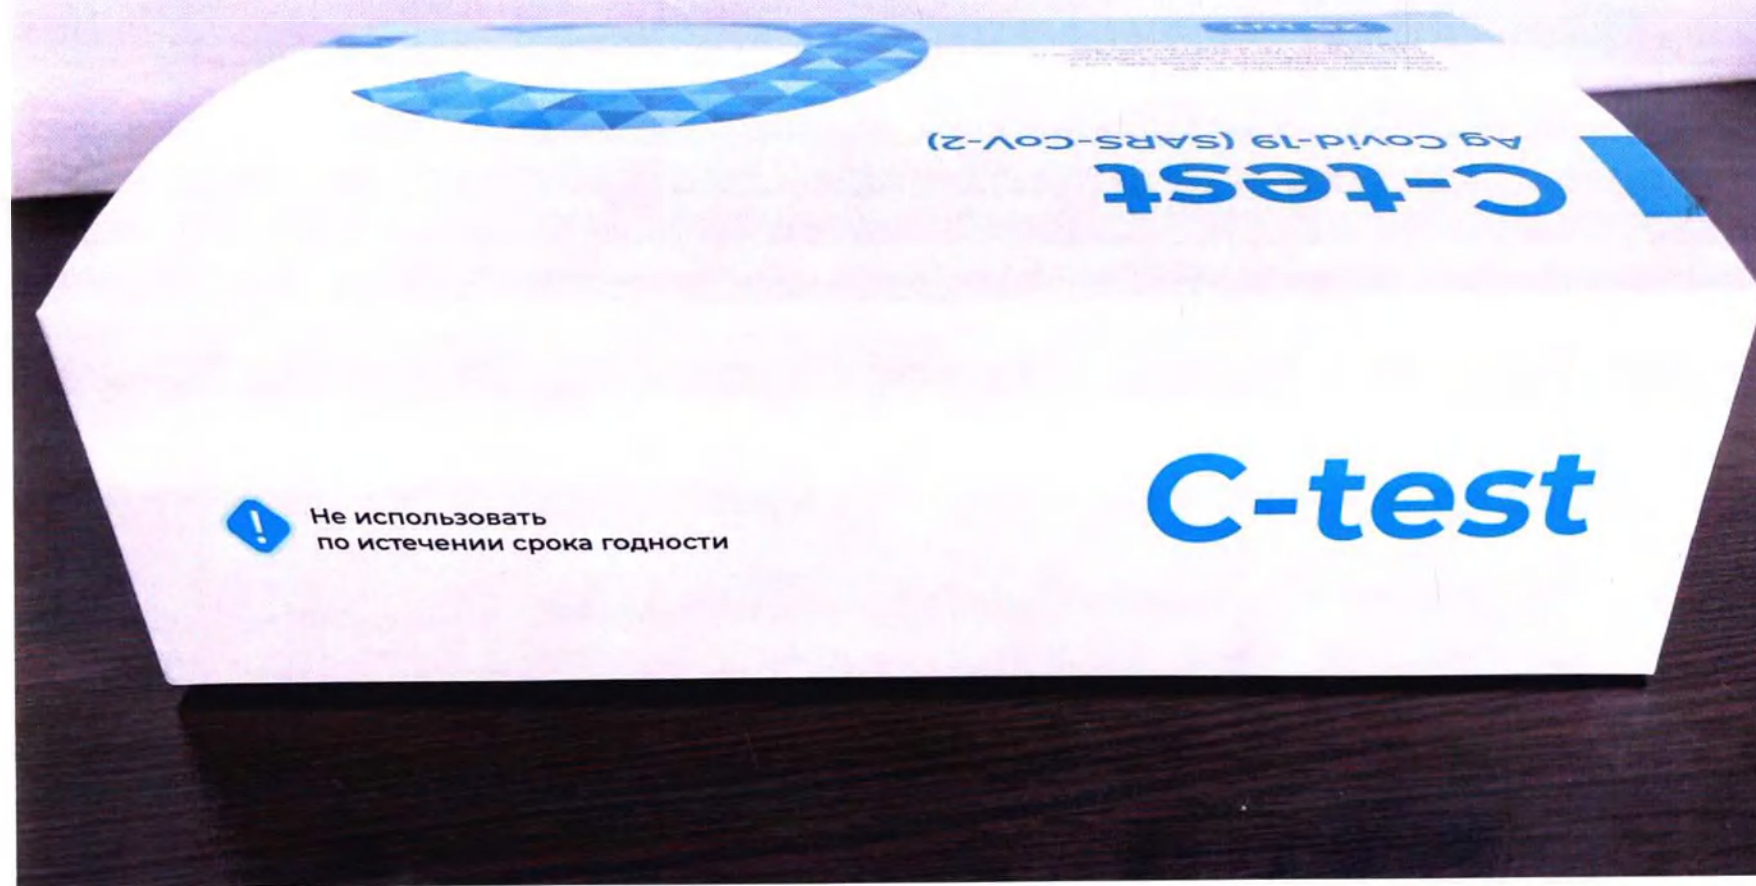

REF AGCOV-19-5

Комплект № 5 (рассчитан на исследование 25 образцов)

Состав набора:

Тест-картридж (в индивидуальной упаковке из фольги в комплекте с осушителем)	25 шт.
Пластиковая пробирка с насадкой-капельницей с буферным раствором 0,3 мл	25 шт.
Зонд медицинский одноразовый стерильный по ТУ 32.50.13-002-28731857-2020 производства ООО "ФармМедПолис РТ", Россия (РУ РЗН № 2021/13989 от 26.11.2021)	25 шт.
Инструкция по применению	1 шт.



Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 2х листов.
Управляющий
ООО "Контрольный тест"
ИП Син О.В.