

Фотографии медицинского изделия для диагностики *in vitro*

**«Набор реагентов для калибровки «Калибраторы Magnolia
тиреоглобулин», по ТУ 21.20.23-538-98539446-2020»,
производства ООО «Компания Алкор Био»**

Вариант исполнения 1	стр. 2,3,4
Вариант исполнения 2	стр. 5,6,7
Калибраторы 1,2,3,4	стр. 8,9,10,11

**Генеральный директор
ООО «Компания Алкор Био»**




Полынцев Д.Г.

ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E005

Набор реагентов для калибровки «Калибраторы MagnoLIA
тиреоглобулин», по ТУ 21.20.23-538-98539446-2020

Кат. № 1290101 Серия № E005 Формирование № 1 Количество 100 шт

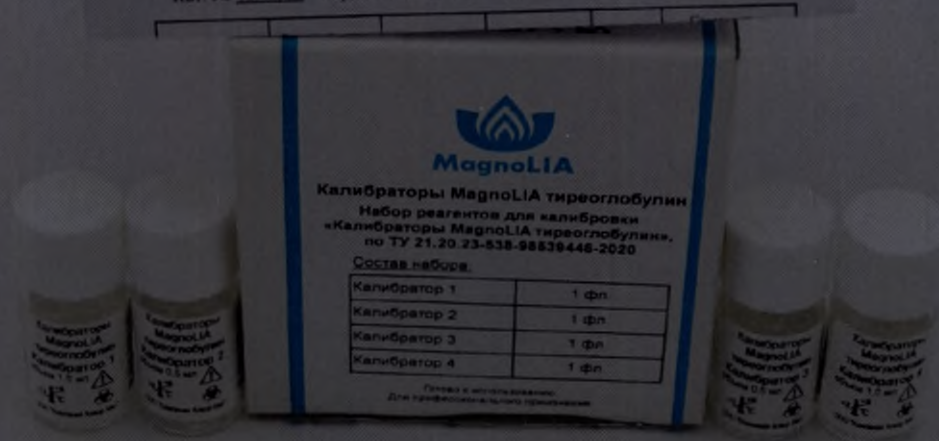

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Медицинского изделия для диагностики in vitro
«Набор реагентов для калибровки
«Калибраторы MagnoLIA тиреоглобулин»,
по ТУ 21.20.23-538-98539446-2020»

ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E005

**Набор реагентов для калибровки «Калибраторы MagnoLIA
тиреоглобулин», по ТУ 21.20.23-538-98539446-2020**

Кат. № 1290101 Серия № E005 Формирование № 1 Количество 100 шт.

LOT	E005		2021-12-23		
REF	1290101		2022-12-23		
IVD					

Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют
ТУ 21 20.23-538-98539446-2020
РУ № XXXXXXXXXXXXXXX

 ООО «Компания Алкор Био»,
192148, Россия, г. Санкт-Петербург,
Железнодорожный пр., д. 40, лит А
тел./факс: +7(812)6778779; 6772162
info@alkorbio.ru, www.alkorbio.ru

Калибраторы
MagnoLIA
тиреоглобулин
Калибратор 1
объем 1,0 мл

ООО «Компания Алкор Био»

Калибраторы
MagnoLIA
тиреоглобулин
Калибратор 2
объем 0,5 мл

ООО «Компания Алкор Био»

Калибраторы
MagnoLIA
тиреоглобулин
Калибратор 3
объем 0,5 мл

ООО «Компания Алкор Био»

Калибраторы
MagnoLIA
тиреоглобулин
Калибратор 4
объем 1,0 мл


ООО «Компания Алкор Био»

ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

П А С П О Р Т № E005

Набор реагентов для калибровки «Калибраторы MagnoLIA
тиреоглобулин», по ТУ 21.20.23-538-98539446-2020

Кат. № 1290101 Серия № E005 Формирование № 1 Количество 100 шт.

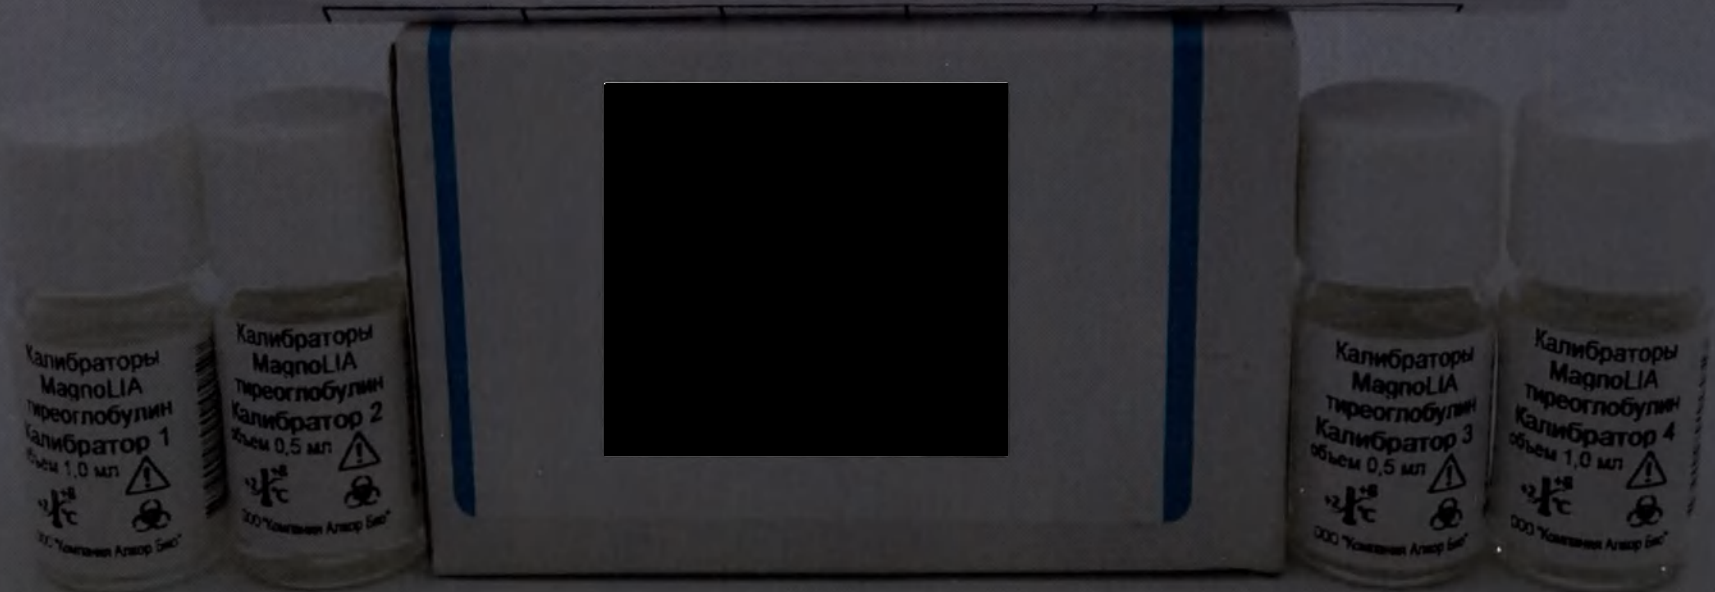

ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E005

Набор реагентов для калибровки «Калибраторы MagnoLIA тиреоглобулин»
по ТУ 21.20.23-538-98539446-2020

Кат. № 1290105 Серия № E005 Формирование № 1 Количество 100 шт.



Калибраторы MagnoLIA тиреоглобулин
Набор реагентов для калибровки «Калибраторы MagnoLIA тиреоглобулин»,
по ТУ 21.20.23-538-98539446-2020

Состав набора

Калибратор 1	5 фл.
Калибратор 2	5 фл.
Калибратор 3	5 фл.
Калибратор 4	5 фл.

ТУ 21.20.23-538-98539446-2020
ТУ № XXXXXXXXXX

LOT E005

REF 1290105

IVD

2021-12-23

2022-12-23

2 60



Готово к использованию
Для профессионального применения
Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HbAg отсутствуют

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Медицинского изделия для диагностики in vitro
«Набор реагентов для калибровки
«Калибраторы MagnoLIA тиреоглобулин»,
по ТУ 21.20.23-538-98539446-2020»

ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E005

Набор реагентов для калибровки «Калибраторы MagnoLIA
тиреоглобулин», по ТУ 21.20.23-538-98539446-2020

Кат. № 1290105 Серия № E005 Формирование № 1 Количество 100 шт.

Калибраторы MagnoLIA тиреоглобулин

LOT E005

2022-12-23

REF 1290105

+2[±]8
°C



ООО «Компания Алкор Био»,
182148, Россия, г. Санкт-Петербург,
Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
т/ф: (812) 677-87-79, 6772162
info@alkorbio.ru, www.alkorbio.ru


ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79


ПАСПОРТ № E005


Набор реагентов для калибровки «Калибраторы Magnolia
тиреоглобулин», по ТУ 21.20.23-538-98539446-2020

Кат. № 1290105 Серия № E005 Формирование № 1 Количество 100 шт

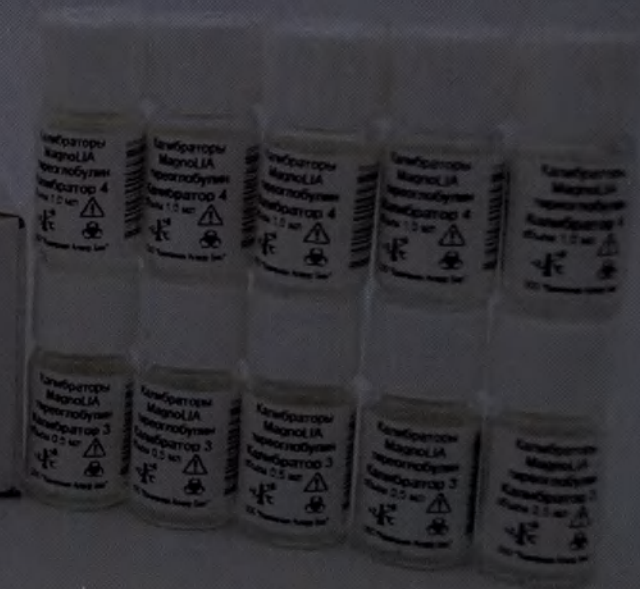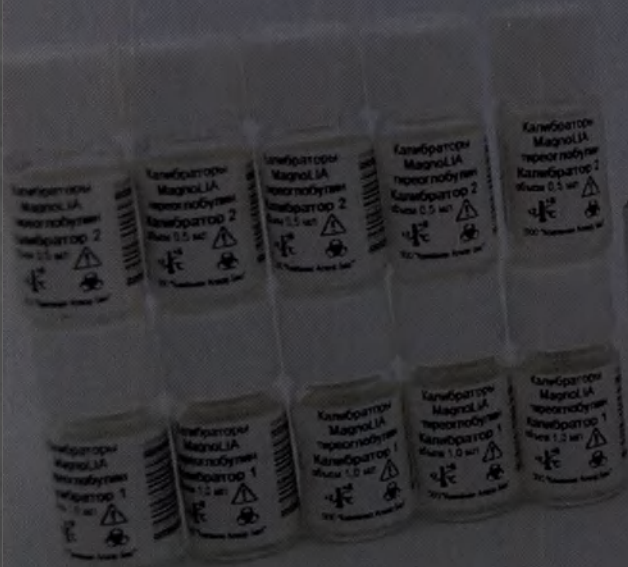

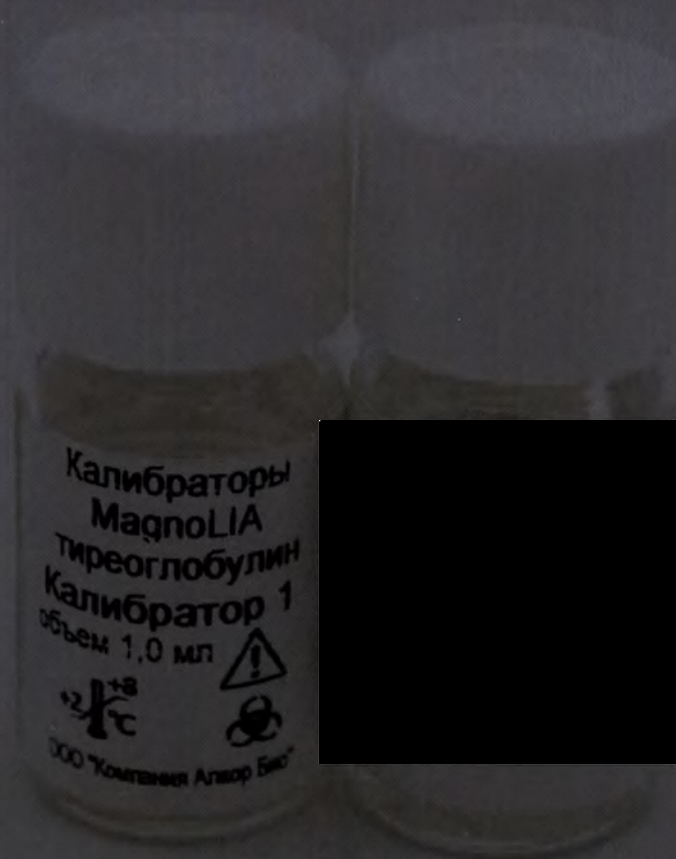

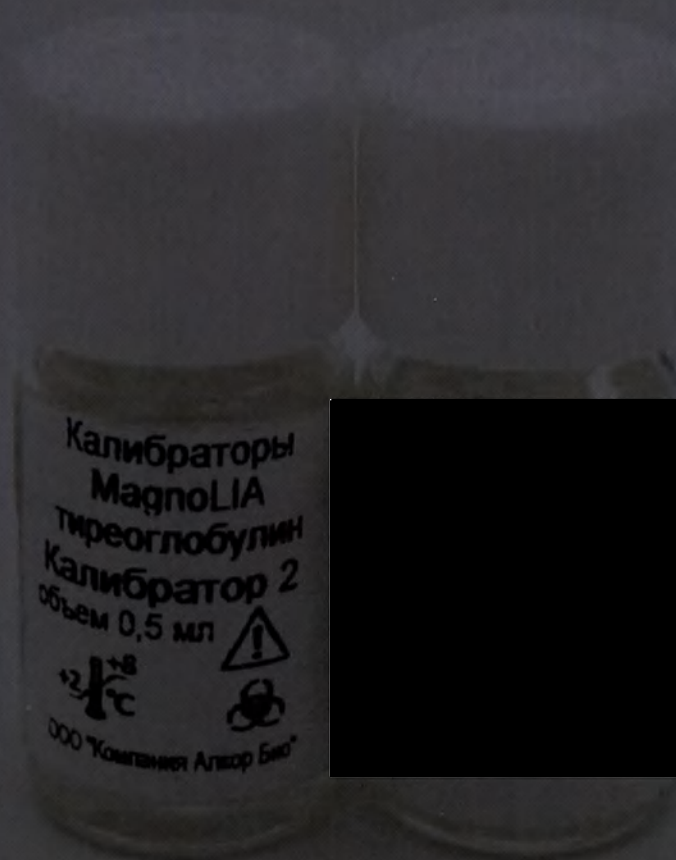

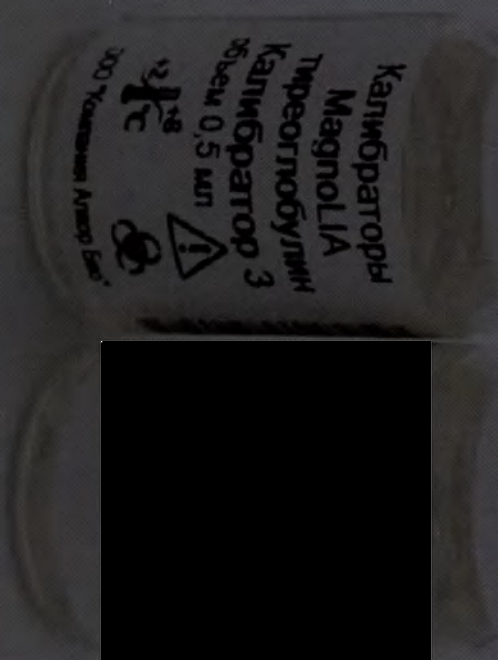



Калинбипаторы
Magnolia
Трехфазный
Калинбипатор 4
объем 1,0 мл
УК
ООО Цирми Асеп Бид

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью

11 (одиннадцать) лист 80

Генеральный директор

ООО «Компания Алкор Био»

Д.Г. Полинцев



Макеты этикеток на медицинское изделие

**«Набор реагентов для калибровки «Калибраторы MagnoLIA
тиреоглобулин», по ТУ 21.20.23-538-98539446-2020»,
производства ООО «Компания Алкор Био»**

**Генеральный директор
ООО «Компания Алкор Био»**



Полынцев Д.Г.

«Набор реагентов для калибровки
«Калибраторы MagnoLIA тиреоглобулин», по ТУ 21.20.23-538-98539446-2020»

Макет этикеток



Вариант исполнения 1

Кат. № 1290101

На коробку:



Калибраторы MagnoLIA тиреоглобулин
Набор реагентов для калибровки
«Калибраторы MagnoLIA тиреоглобулин»,
по ТУ 21.20.23-538-98539446-2020

Состав набора:

Калибратор 1	1 фл.
Калибратор 2	1 фл.
Калибратор 3	1 фл.
Калибратор 4	1 фл.

Готово к использованию
Для профессионального применения.



Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют
ТУ 21.20.23-538-98539446-2020
РУ № XXXXXXXXXXXXXXX

ООО «Компания Алкор Био»,
192148, Россия, г. Санкт-Петербург,
Железнодорожный пр., д. 40, лит А
т +7(812)6778779; 6772162
info@alkorbio.ru, www.alkorbio.ru

На флаконы:

Калибраторы
MagnoLIA
тиреоглобулин
Калибратор 1
объем 1,0 мл
+25°C
000 «Компания Алкор Био»



Калибраторы
MagnoLIA
тиреоглобулин
Калибратор 2
объем 0,5 мл
+25°C
000 «Компания Алкор Био»



Калибраторы
MagnoLIA
тиреоглобулин
Калибратор 3
объем 0,5 мл
+25°C
000 «Компания Алкор Био»



Калибраторы
MagnoLIA
тиреоглобулин
Калибратор 4
объем 1,0 мл
+25°C
000 «Компания Алкор Био»



«Набор реагентов для калибровки
«Калибраторы MagnoLIA тиреоглобулин», по ТУ 21.20.23-538-98539446-2020»

Макет этикеток

ГРУППА КОМПАНИЙ
АЛКОР БИО

Вариант исполнения 2

Кат. № 1290105

На коробку:

Калибраторы MagnoLIA тиреоглобулин

LOT E005
REF 1290105

2023-12-23

ООО «Компания Алкор Био»,
125144, Россия, г. Санкт-Петербург,
Митяевский пр., д. 40, лит. А
телефон: +7(812)9778178, 8772102
info@alcorbio.ru, www.alcorbio.ru



Калибраторы MagnoLIA тиреоглобулин
Набор реагентов для калибровки «Калибраторы MagnoLIA тиреоглобулин»,
по ТУ 21.20.23-538-98539446-2020

Состав набора:

Калибратор 1	5 фл.
Калибратор 2	5 фл.
Калибратор 3	5 фл.
Калибратор 4	5 фл.

LOT E005

REF 1290105

IVD

2021-12-23


2022-12-23

50

+2⁺8
°C

i

!




ТУ 21.20.23-538-98539446-2020
РУ № XXXXXXXXXXXXXXXX

Готово к использованию.
Для профессионального применения.
Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют.


На флаконы:

Калибраторы
MagnoLIA
тиреоглобулин
Калибратор 1
объем 1,0 мл




- 5 шт.

Калибраторы
MagnoLIA
тиреоглобулин
Калибратор 2
объем 0,5 мл





- 5 шт.

Калибраторы
MagnoLIA
тиреоглобулин
Калибратор 3
объем 0,5 мл



- 5 шт.

Калибраторы
MagnoLIA
тиреоглобулин
Калибратор 4
объем 1,0 мл



- 5 шт.

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью

3 () лист 9

Генеральный директор
ООО «Компания Алкор Био» Д.Г. Полинцев

