

Макеты этикеток на медицинское изделие

**«Набор реагентов для калибровки «MagnoLIA свободный Т4»,
производства ООО «Компания Алкор Био»**

Генеральный директор
ООО «Компания Алкор Био»



Полинцев Д.Г.

Вариант исполнения 1

Кат. № 1090101

На коробку:



Набор реагентов для калибровки
«MagnoLIA свободный T4»,
по ТУ 21.20.23-530-98539446-2020

Состав набора:

Калибратор 1	1 фл.
Калибратор 2	1 фл.
Калибратор 3	1 фл.
Калибратор 4	1 фл.

Готово к использованию.
Для профессионального применения
Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют.



ТУ 21.20.23-530-98539446-2020
РУ №XXXXXXXXXXXXXX

ООО «Компания Алкор Био»,
192148, Россия, г. Санкт-Петербург,
Железнодорожный пр., д. 40, лит А
Тел: +7(812)6778779; 6772162
info@alkorbio.ru, www.alkorbio.ru

На флаконы:

MagnoLIA
свободный T4
Калибратор 1
объем 1,0 мл
+2-8°C
000 «Компания Алкор Био»



- 1 шт.

MagnoLIA
свободный T4
Калибратор 2
объем 0,5 мл
+2-8°C
000 «Компания Алкор Био»



- 1 шт.

MagnoLIA
свободный T4
Калибратор 3
объем 0,5 мл
+2-8°C
000 «Компания Алкор Био»



- 1 шт.

MagnoLIA
свободный T4
Калибратор 4
объем 1,0 мл
+2-8°C
000 «Компания Алкор Био»



- 1 шт.

Вариант исполнения 2

Кат. № 1090105

На коробку:

MagnaLIA

Состав набора:

Калибратор 1	5 фл.
Калибратор 2	5 фл.
Калибратор 3	5 фл.
Калибратор 4	5 фл.

ТУ 21.20.23-530-98539446-2020
РУ № XXXXXXXXXXXXXXX

ООО «Компания Алкор Био»,
187144, Россия, г. Санкт-Петербург,
Железнодорожный пр., д. 40, лит А
тел./факс: +7(812)8787778, 8772162
info@alcorbio.ru, www.alcorbio.ru

LOT E005
REF 1090105
IVD

2021-07-03
2022-07-03

+2⁺8
+3⁺8

50

Набор реагентов для калибровки «MagnaLIA свободный T4», По ТУ 21.20.23-530-98539446-2020

LOT E005

2021-07-03

+2⁺8




REF 1090105

2022-07-03



IVD

50



Готово к использованию.
Для профессионального применения.
Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют.

На флаконы:

MagnaLIA
свободный T4
Калибратор 1
объем 1,0 мл
+2⁺8
ООО «Компания Алкор Био»



-5 шт.

MagnaLIA
свободный T4
Калибратор 3
объем 0,5 мл
+2⁺8
ООО «Компания Алкор Био»



-5 шт.

MagnaLIA
свободный T4
Калибратор 2
объем 0,5 мл
+2⁺8
ООО «Компания Алкор Био»



-5 шт.

MagnaLIA
свободный T4
Калибратор 4
объем 1,0 мл
+2⁺8
ООО «Компания Алкор Био»



-5 шт.

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью

3 (711) лист 1

Генеральный директор

ООО «Компания Алкор Био»

Д.Г. Полинцев



Фотографии медицинского изделия для диагностики *in vitro*

«Набор реагентов для калибровки «MagnoLIA свободный Т4», по ТУ 21.20.23-530-98539446-2020, производства ООО «Компания Алкор Био»

Вариант исполнения 1	стр. 2,3,4
Вариант исполнения 2	стр. 5,6,7
Калибраторы 1,2,3,4	стр. 8,9,10,11

Генеральный директор
ООО «Компания Алкор Био»



Полынцев Д.Г.

ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E002

Набор реагентов для калибровки
«MagnoLIA свободный T4»,
по ТУ 21.20.23-530-98539446-2020

Кат. № 1090101 Серия № E002 Формирование № 1 Количество 100 шт.




ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Медицинского изделия для диагностики *in vitro*
Набор реагентов для калибровки «MagnoLIA свободный T4»,
по ТУ 21.20.23-530-98539446-2020

ООО «Компания Алюр Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E002

Набор реагентов для калибровки
«MagnLIA свободный Т4»
по ТУ 21.20.23-530-98539446-2020

Кат. № 1090101 Серия № E002 Формирование № 1 Количество 100 шт.

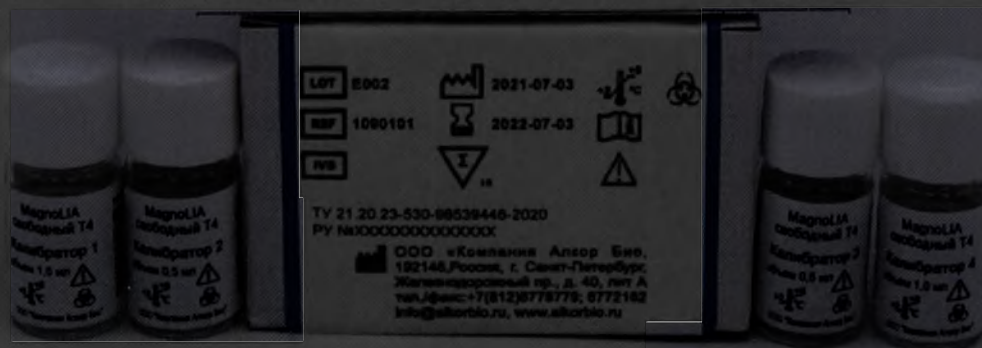

ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

П А С П О Р Т № E002

Набор реагентов для калибровки
«MagneLIA свободный T4»,
по ТУ 21.20.23-530-98539446-2020

Кат. № 1090101 Серия № E002 Формирование № 1 Количество 100 шт.

ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E002

Набор реагентов для калибровки
«MagnaLIA свободный T4»,
по ТУ 21.20.23-530-98539446-2020

Кат. № 1090105 Серия № E002. Формирование № 1. Количество 100 шт.



Набор реагентов для калибровки
«MagnaLIA свободный T4», По ТУ 21.20.23-530-98539446-2020

Состав набора:

Калибратор 1	5 фл.
Калибратор 2	5 фл.
Калибратор 3	5 фл.
Калибратор 4	5 фл.

LOT E002

2021-07-03



REF 1090105

2022-07-03




PVP



ТУ 21.20.23-530-98539446-2020
РУ № ХХХХХХХХХХХХХХХХ

Готово к использованию
Для профессионального применения
Аптеками с ВПН 1,2 и в аптеках категории С и МБАпд аптекари.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Медицинского изделия для диагностики *in vitro*
Набор реагентов для калибровки «MagnaLIA свободный T4»,
по ТУ 21.20.23-530-98539446-2020

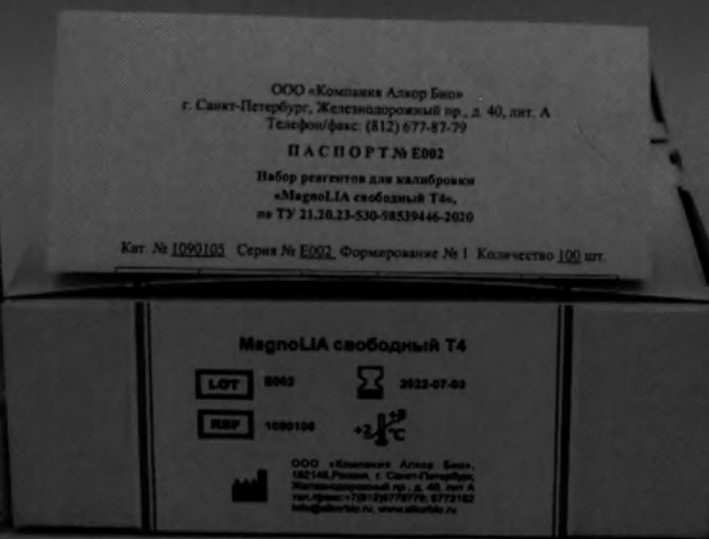

ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-83-79

ПАСПОРТ № E002

Набор реактивов для калибровки
«MagnoLIA» свободный T4»,
по ТУ 21.20.23-510-98539446-2020

Кат. № 1092105 Серия № E002 Формирование № 1 Количество 100 шт.





Прошито, пронумеровано, скреплено печатью

11 (тринадцать) лист 80

Генеральный директор

ООО «Компания Алкор Био»

И.Г. Полинцев

