


ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**Бронхоскоп для одноразового применения EXALT Model B,
варианты исполнения**

производства

Boston Scientific Corporation / «Бостон Сайентифик Корпорейшн»


2022

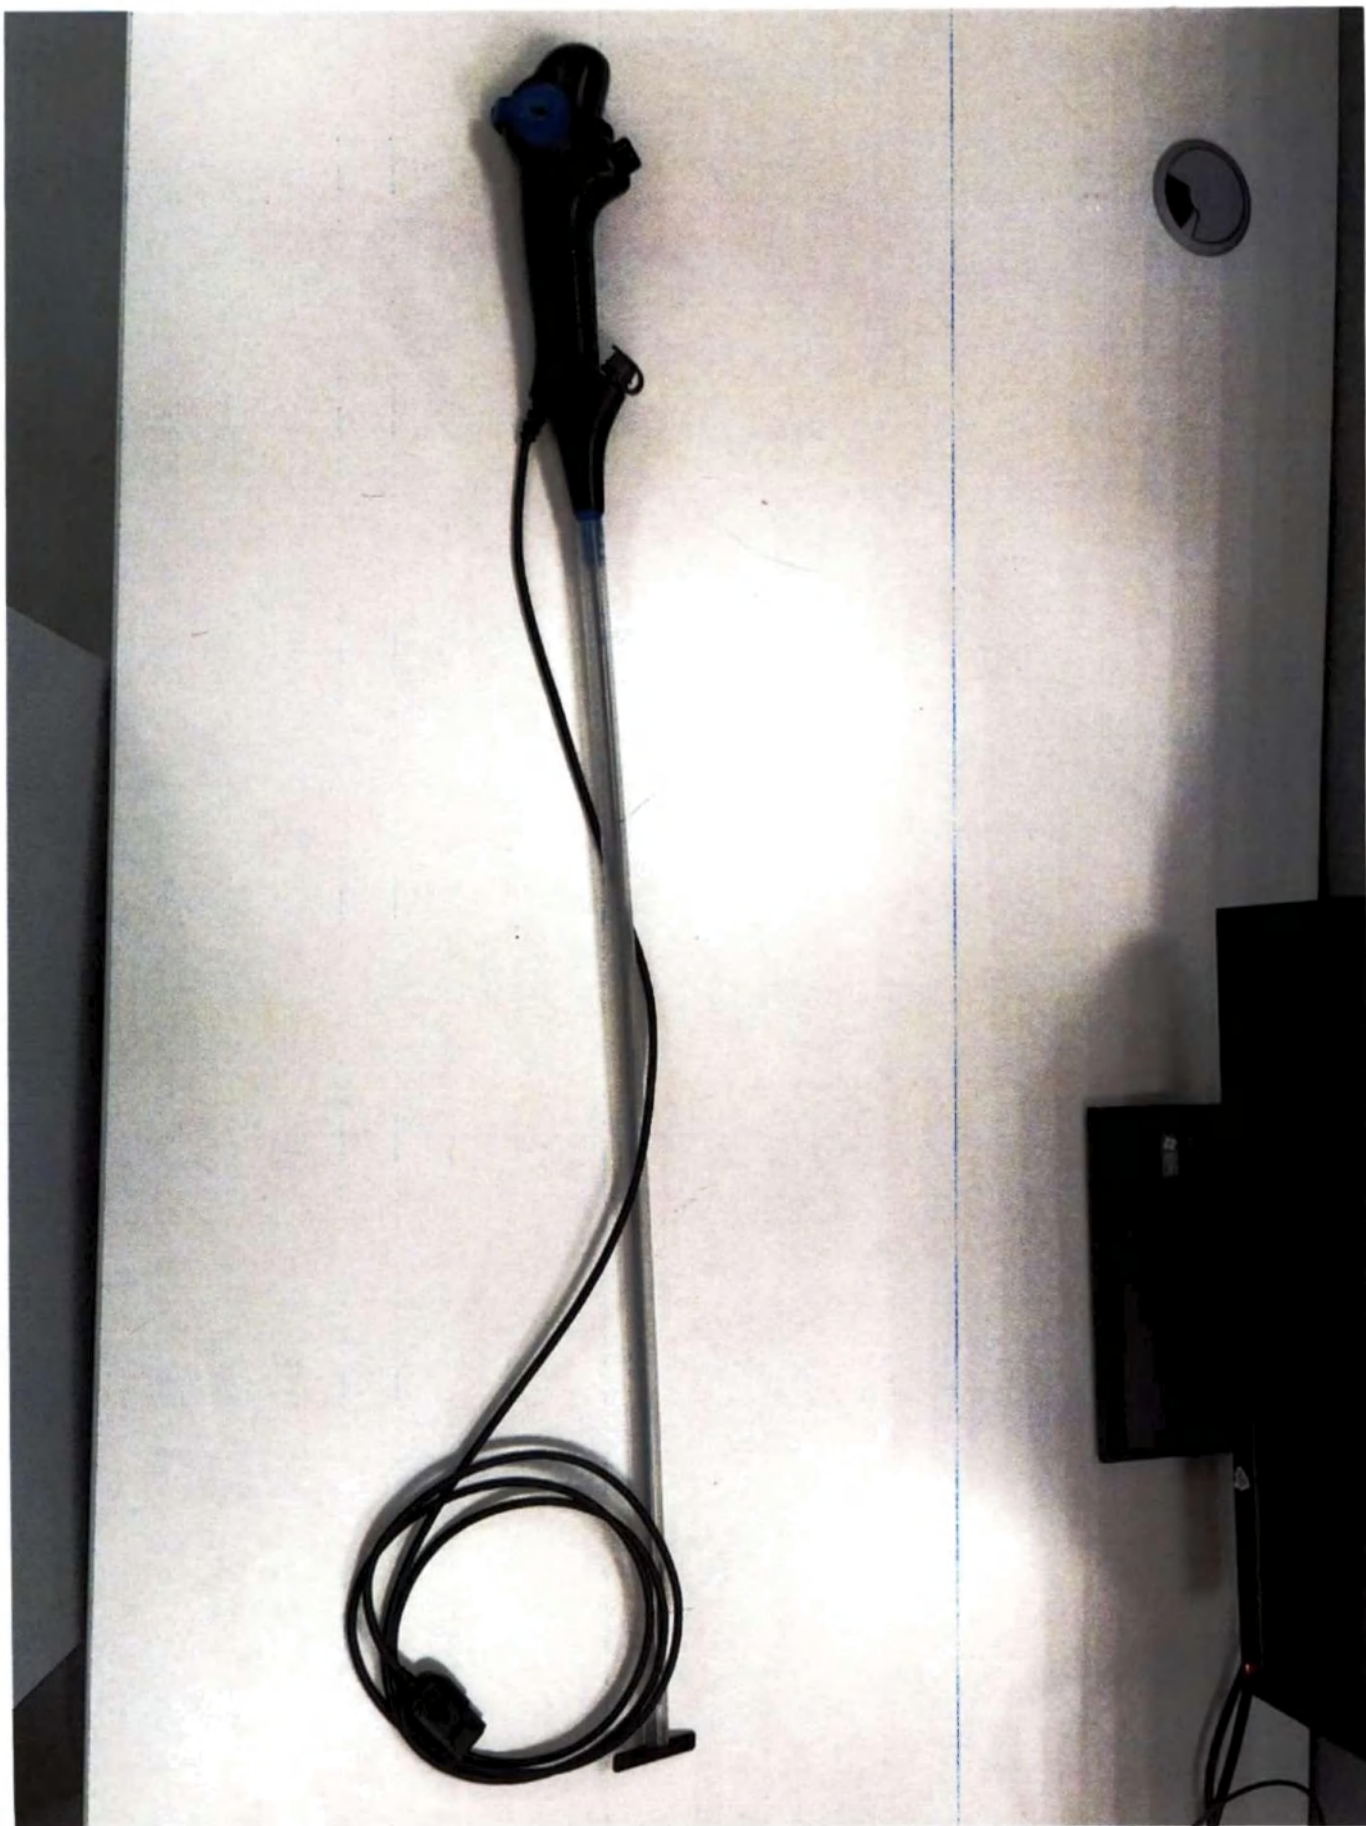


Бронхоскоп для одноразового применения EXALT Model B, средний, внешний диаметр 5,0 мм, средний внутренний диаметр рабочего канала 2,2 мм, общий вид



Бронхоскоп для одноразового применения EXALT Model B, средний, внешний диаметр 5,0 мм, средний внутренний диаметр рабочего канала 2,2 мм – Рукоятка, сторона 1

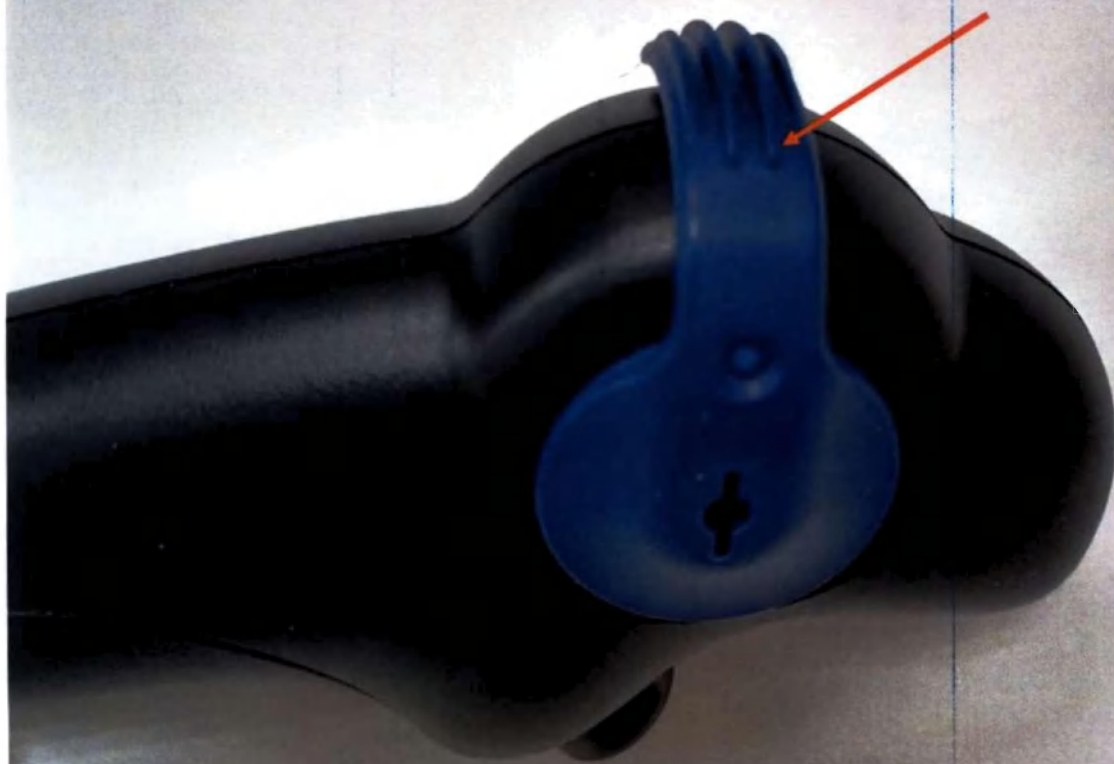

Бронхоскоп для одноразового применения EXALT Model B, средний, внешний диаметр 5,0 мм, средний внутренний диаметр рабочего канала 2,2 мм – Рычаг для большого пальца

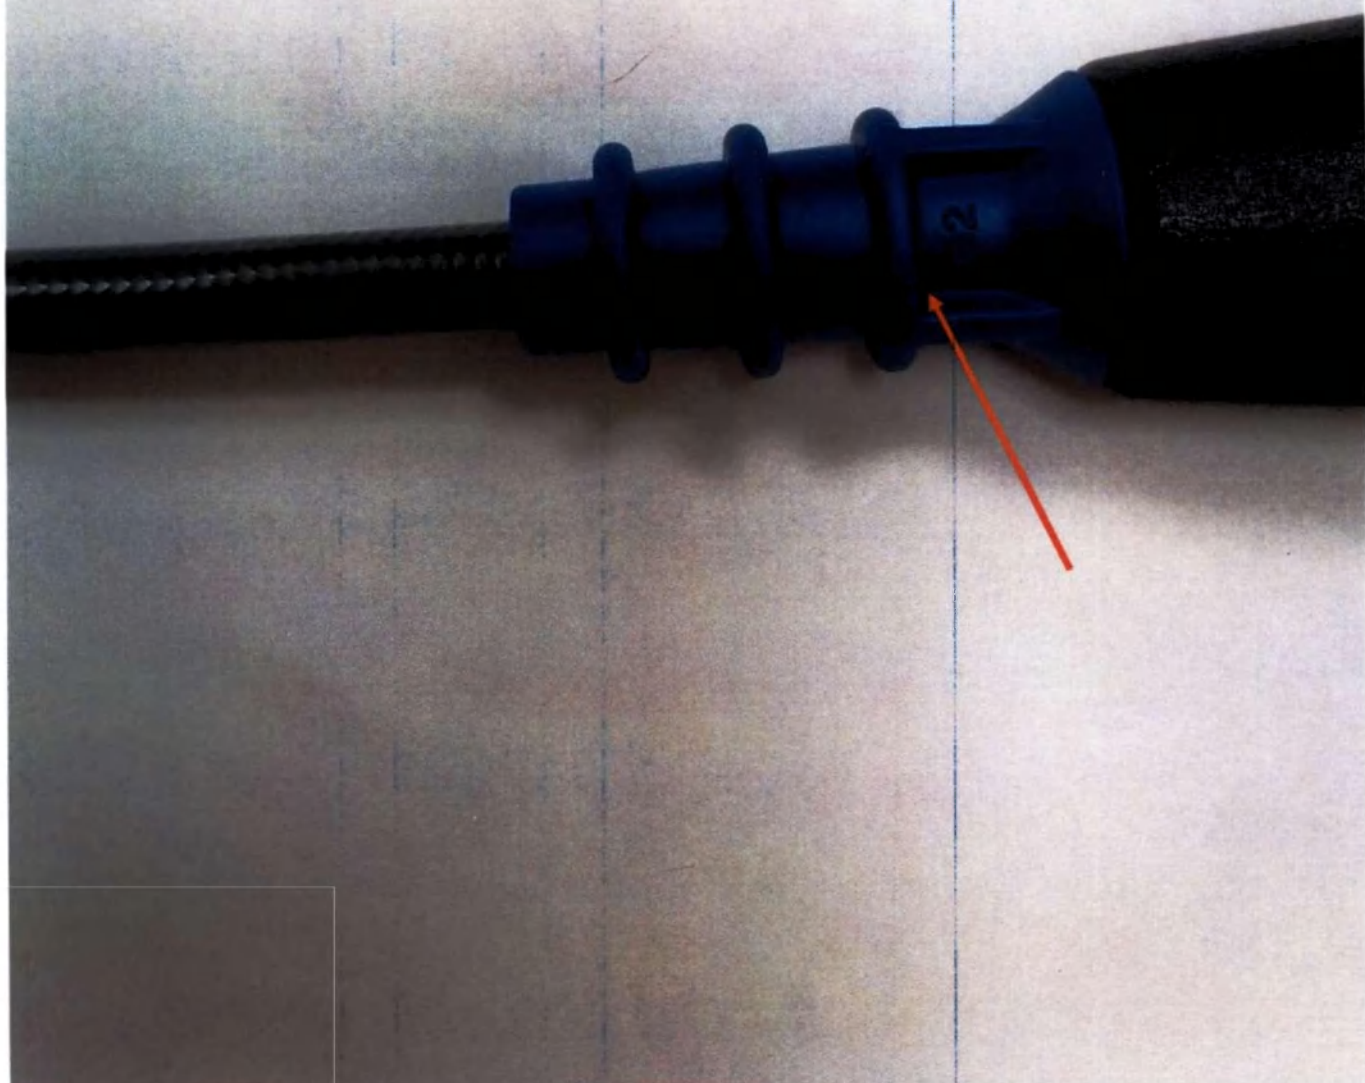

Бронхоскоп для одноразового применения EXALT Model B, средний, внешний диаметр 5,0 мм, средний внутренний диаметр рабочего канала 2,2 мм – Разгрузочная муфта




Бронхоскоп для одноразового применения EXALT Model B, большой, внешний диаметр 5,8 мм, средний внутренний диаметр рабочего канала 2,8 мм, общий вид



Бронхоскоп для одноразового применения EXALT Model B, большой, внешний диаметр 5,8 мм, средний внутренний диаметр рабочего канала 2,8 мм – Рукоятка бронхоскопа, сторона 1



Бронхоскоп для одноразового применения EXALT Model B, большой, внешний диаметр 5,8 мм, средний внутренний диаметр рабочего канала 2,8 мм – Рычаг для большого пальца

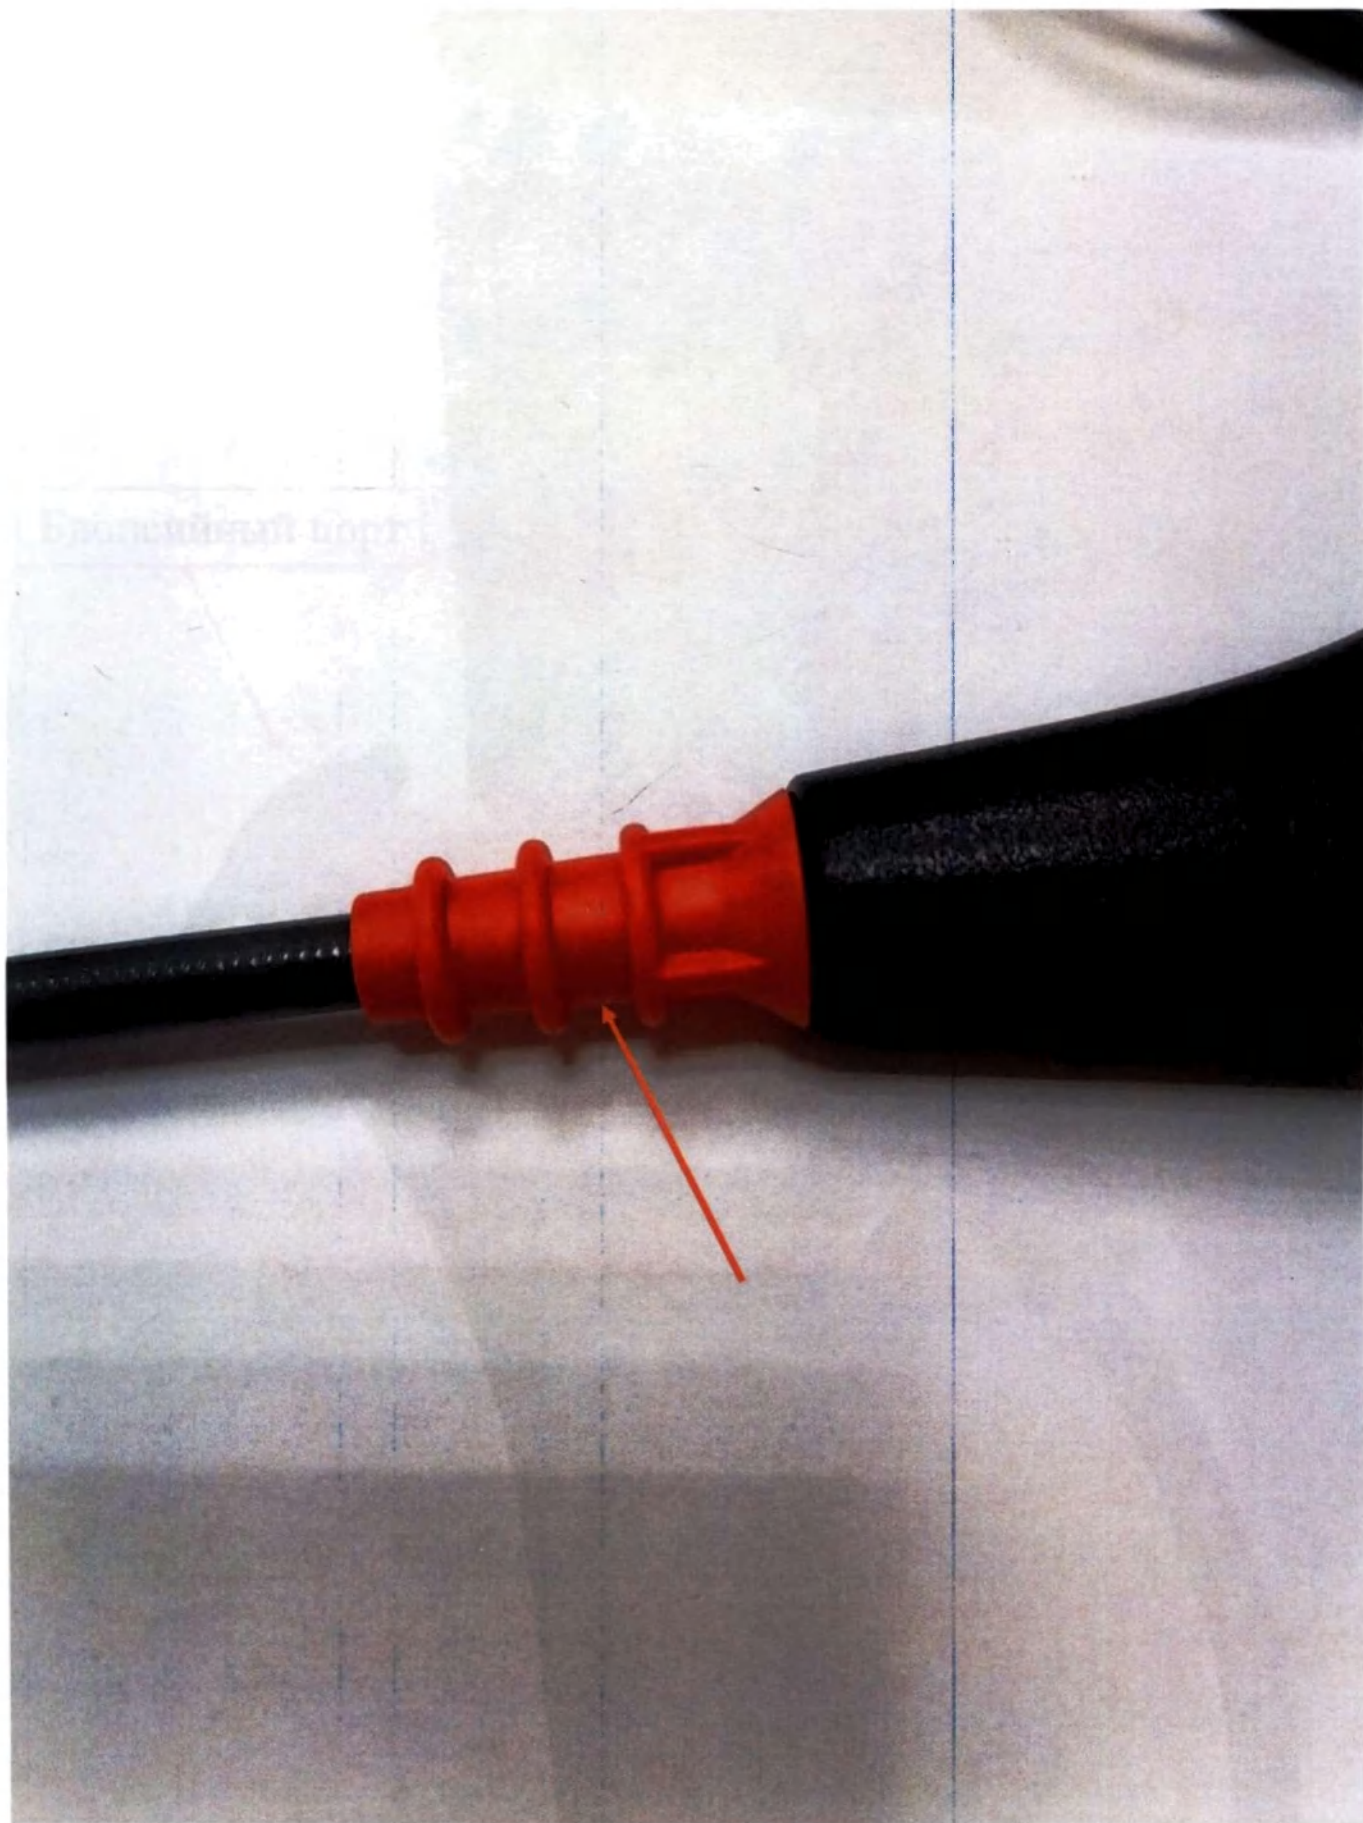

Бронхоскоп для одноразового применения EXALT Model B, большой, внешний диаметр 5,8 мм, средний внутренний диаметр рабочего канала 2,8 мм – Разгрузочная муфта


Биопсийный порт




Рукоятка бронхоскопа, сторона 2



Рукоятка бронхоскопа, сторона 3

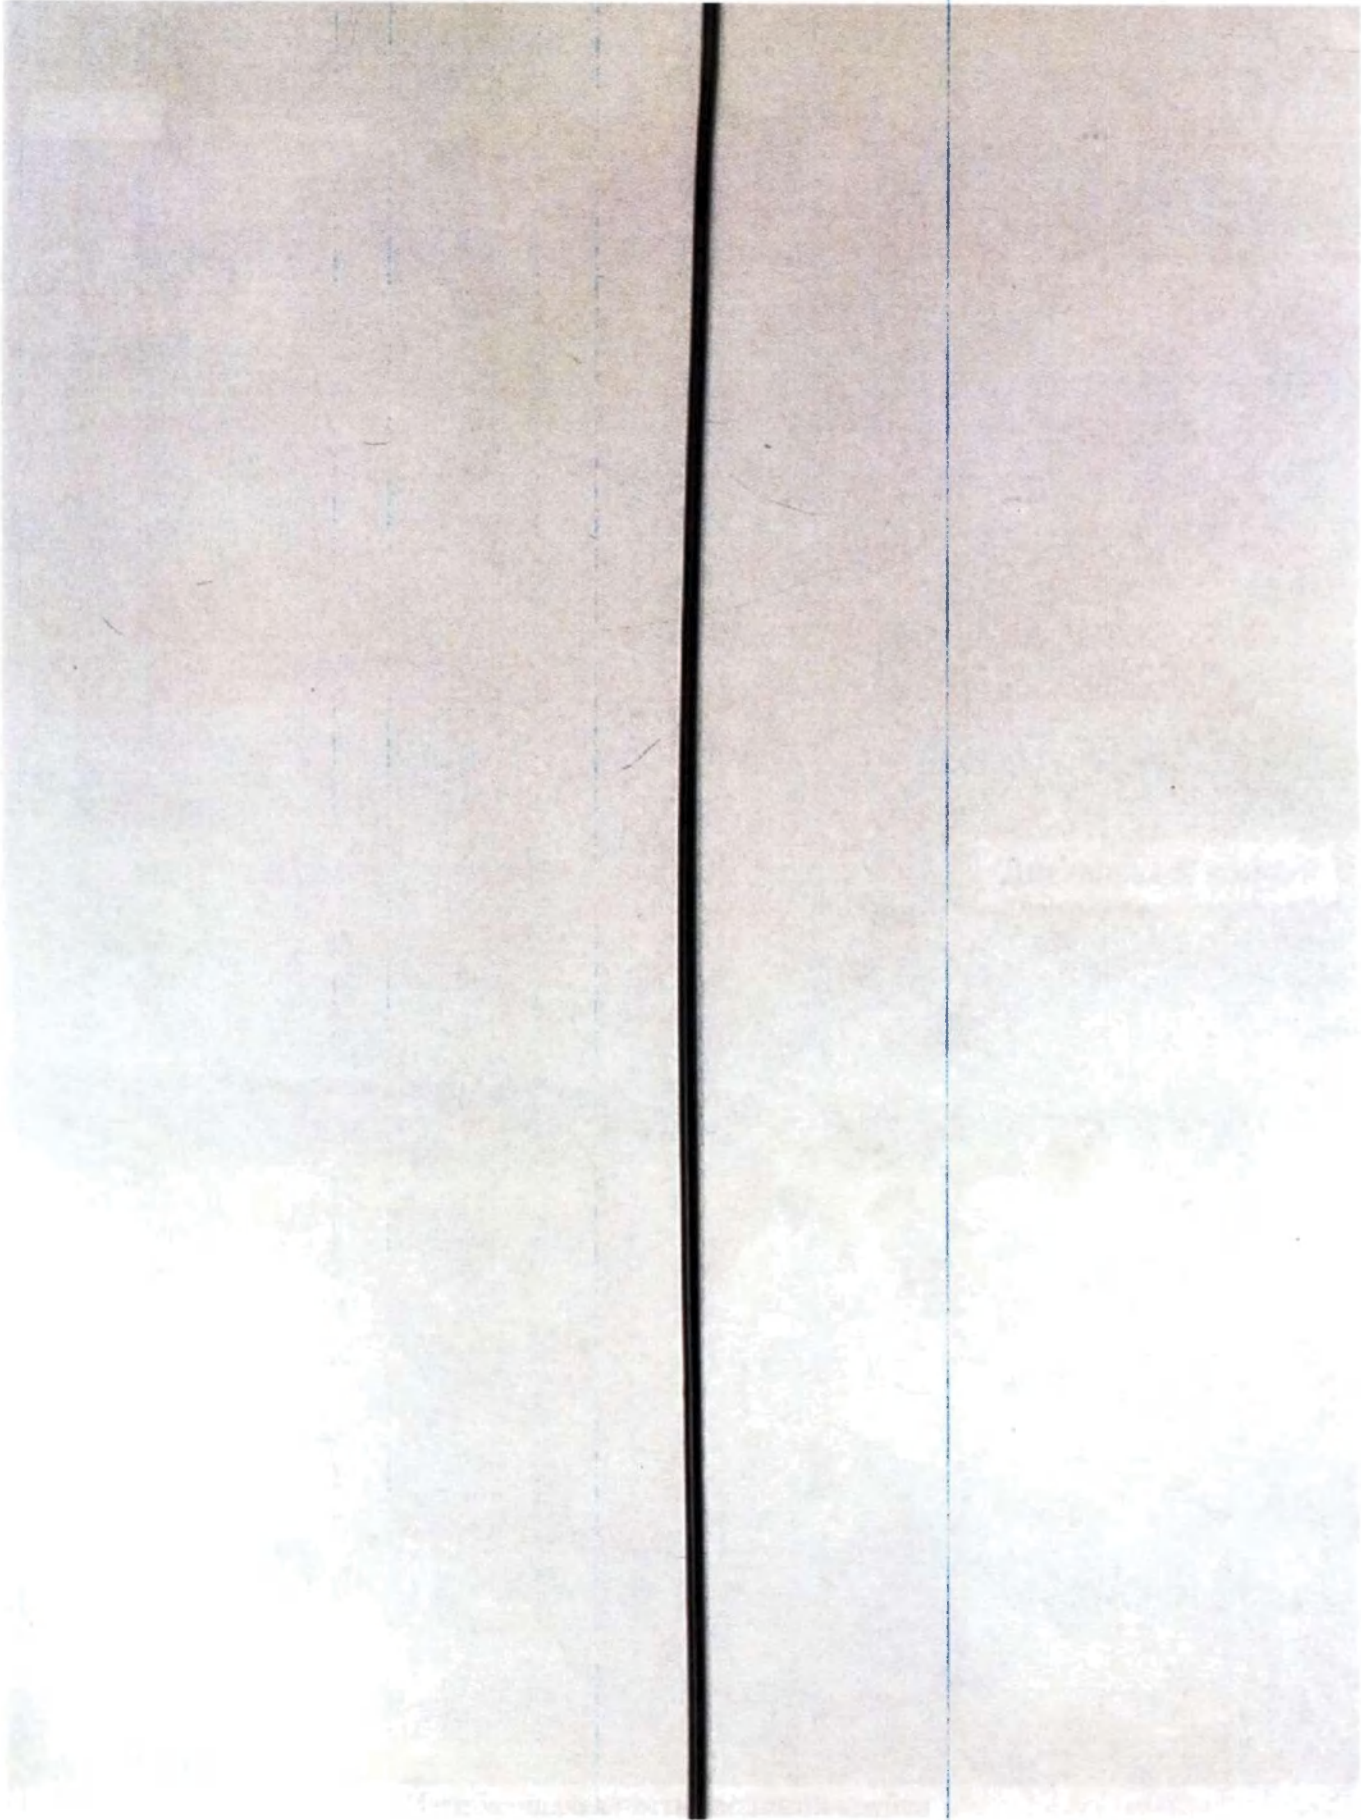

Вводимая трубка

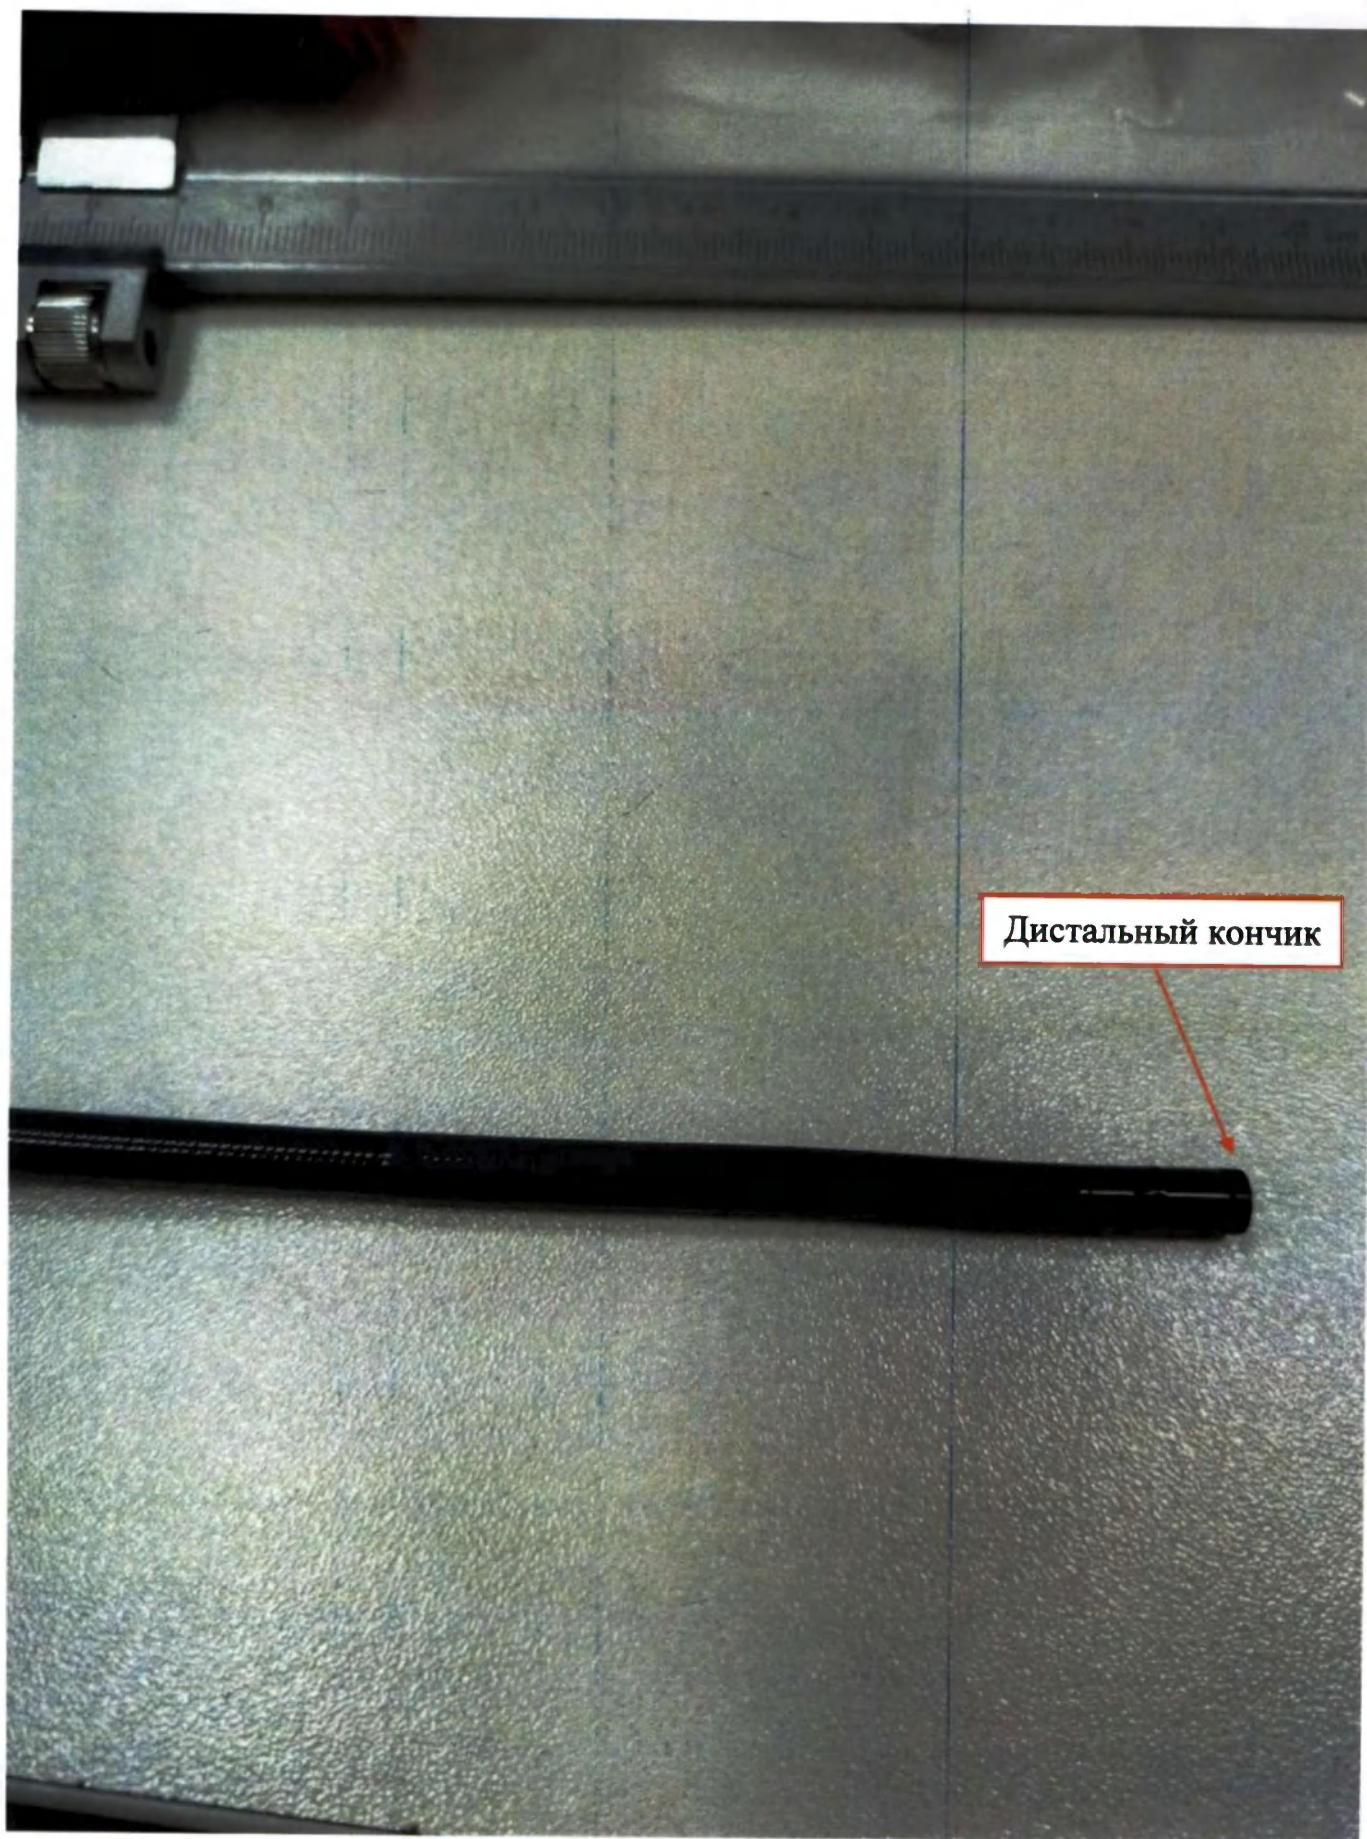

Изгибающаяся часть вводимой трубки




Соединительная часть



Коннектор соединительного провода




Защитный корпус рукоятки

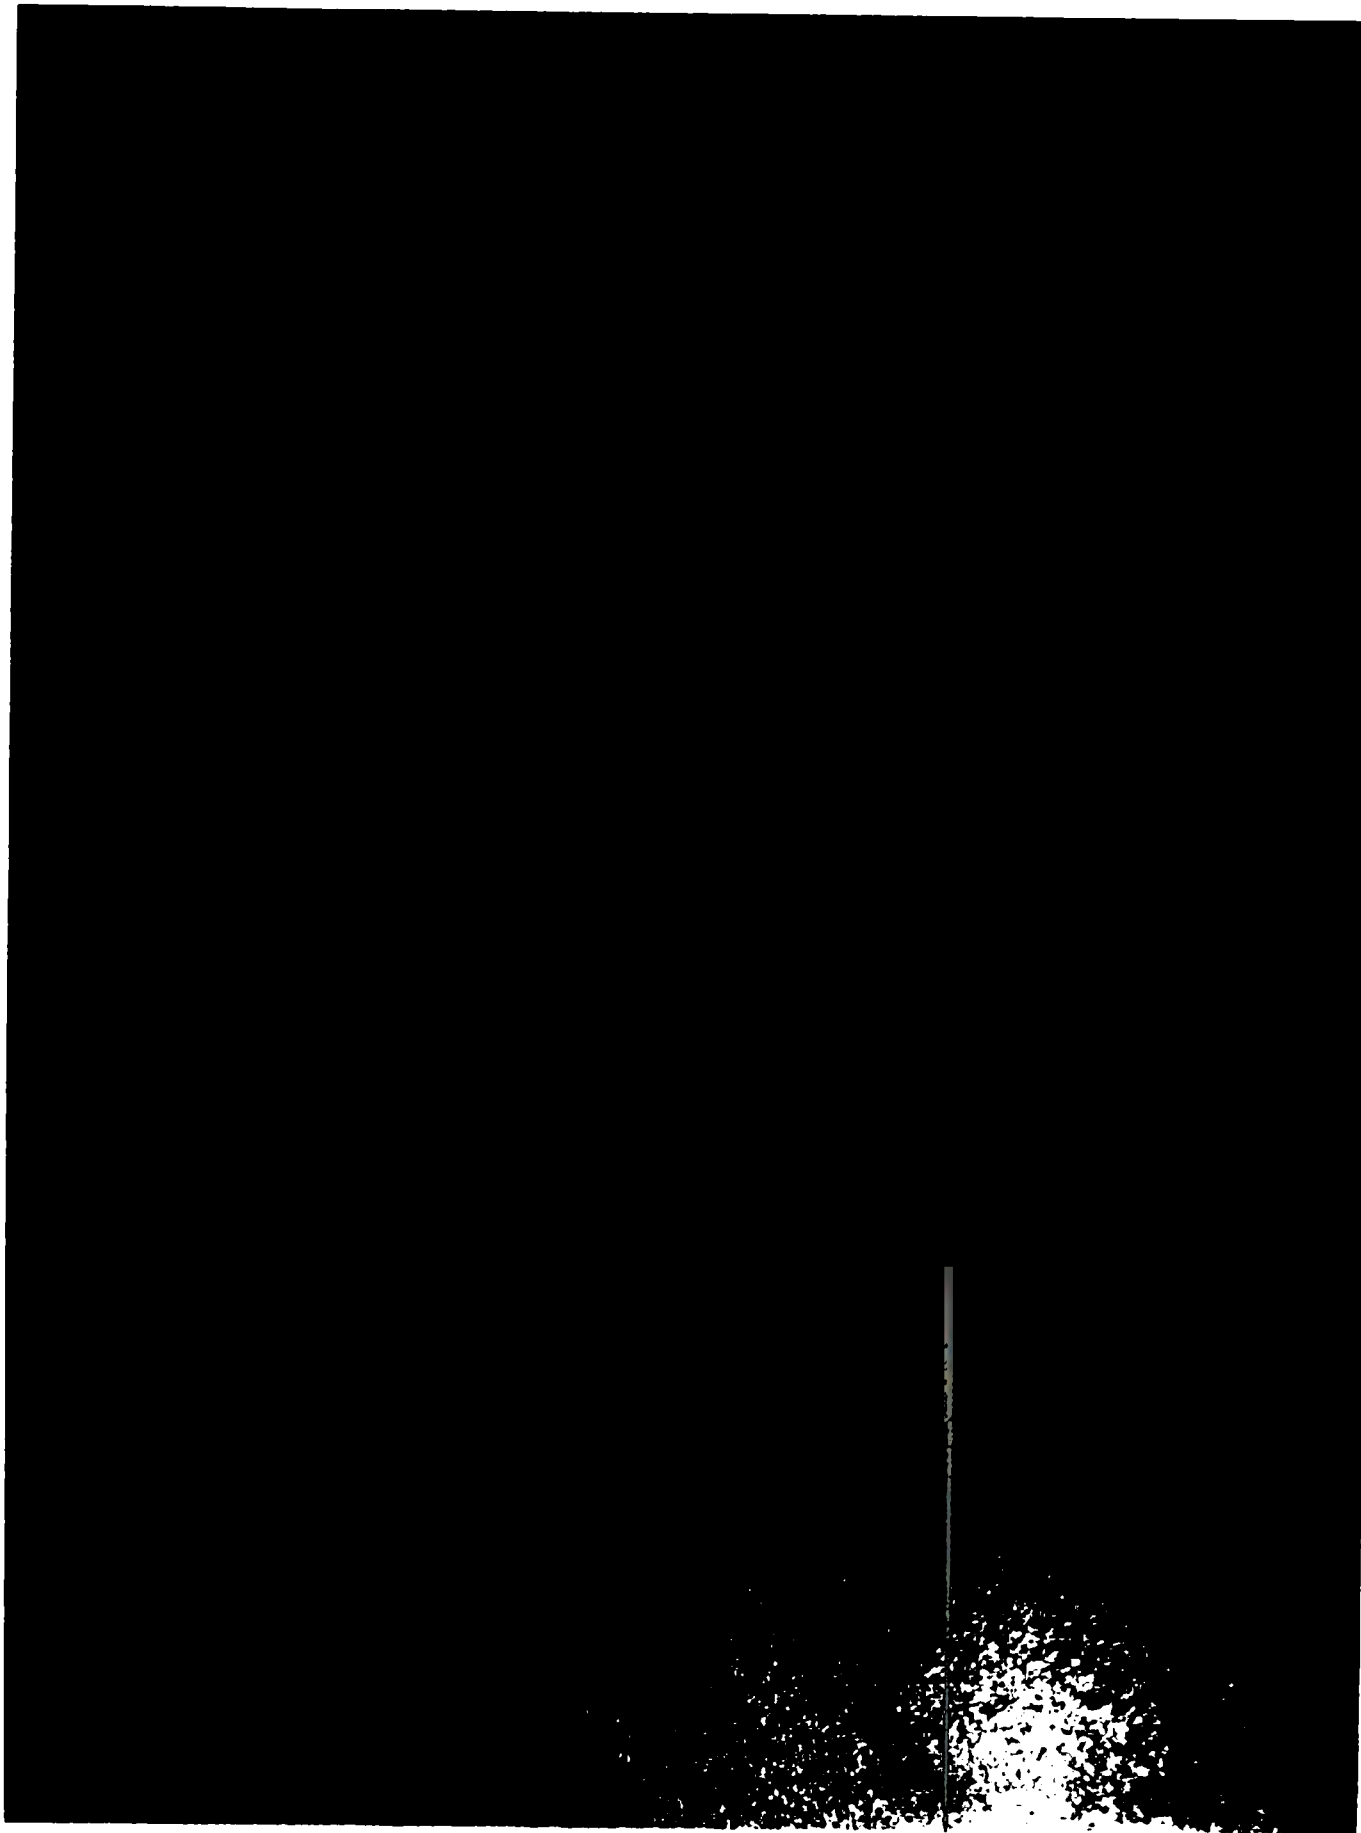

Ремешок рукоятки



Защитная трубка

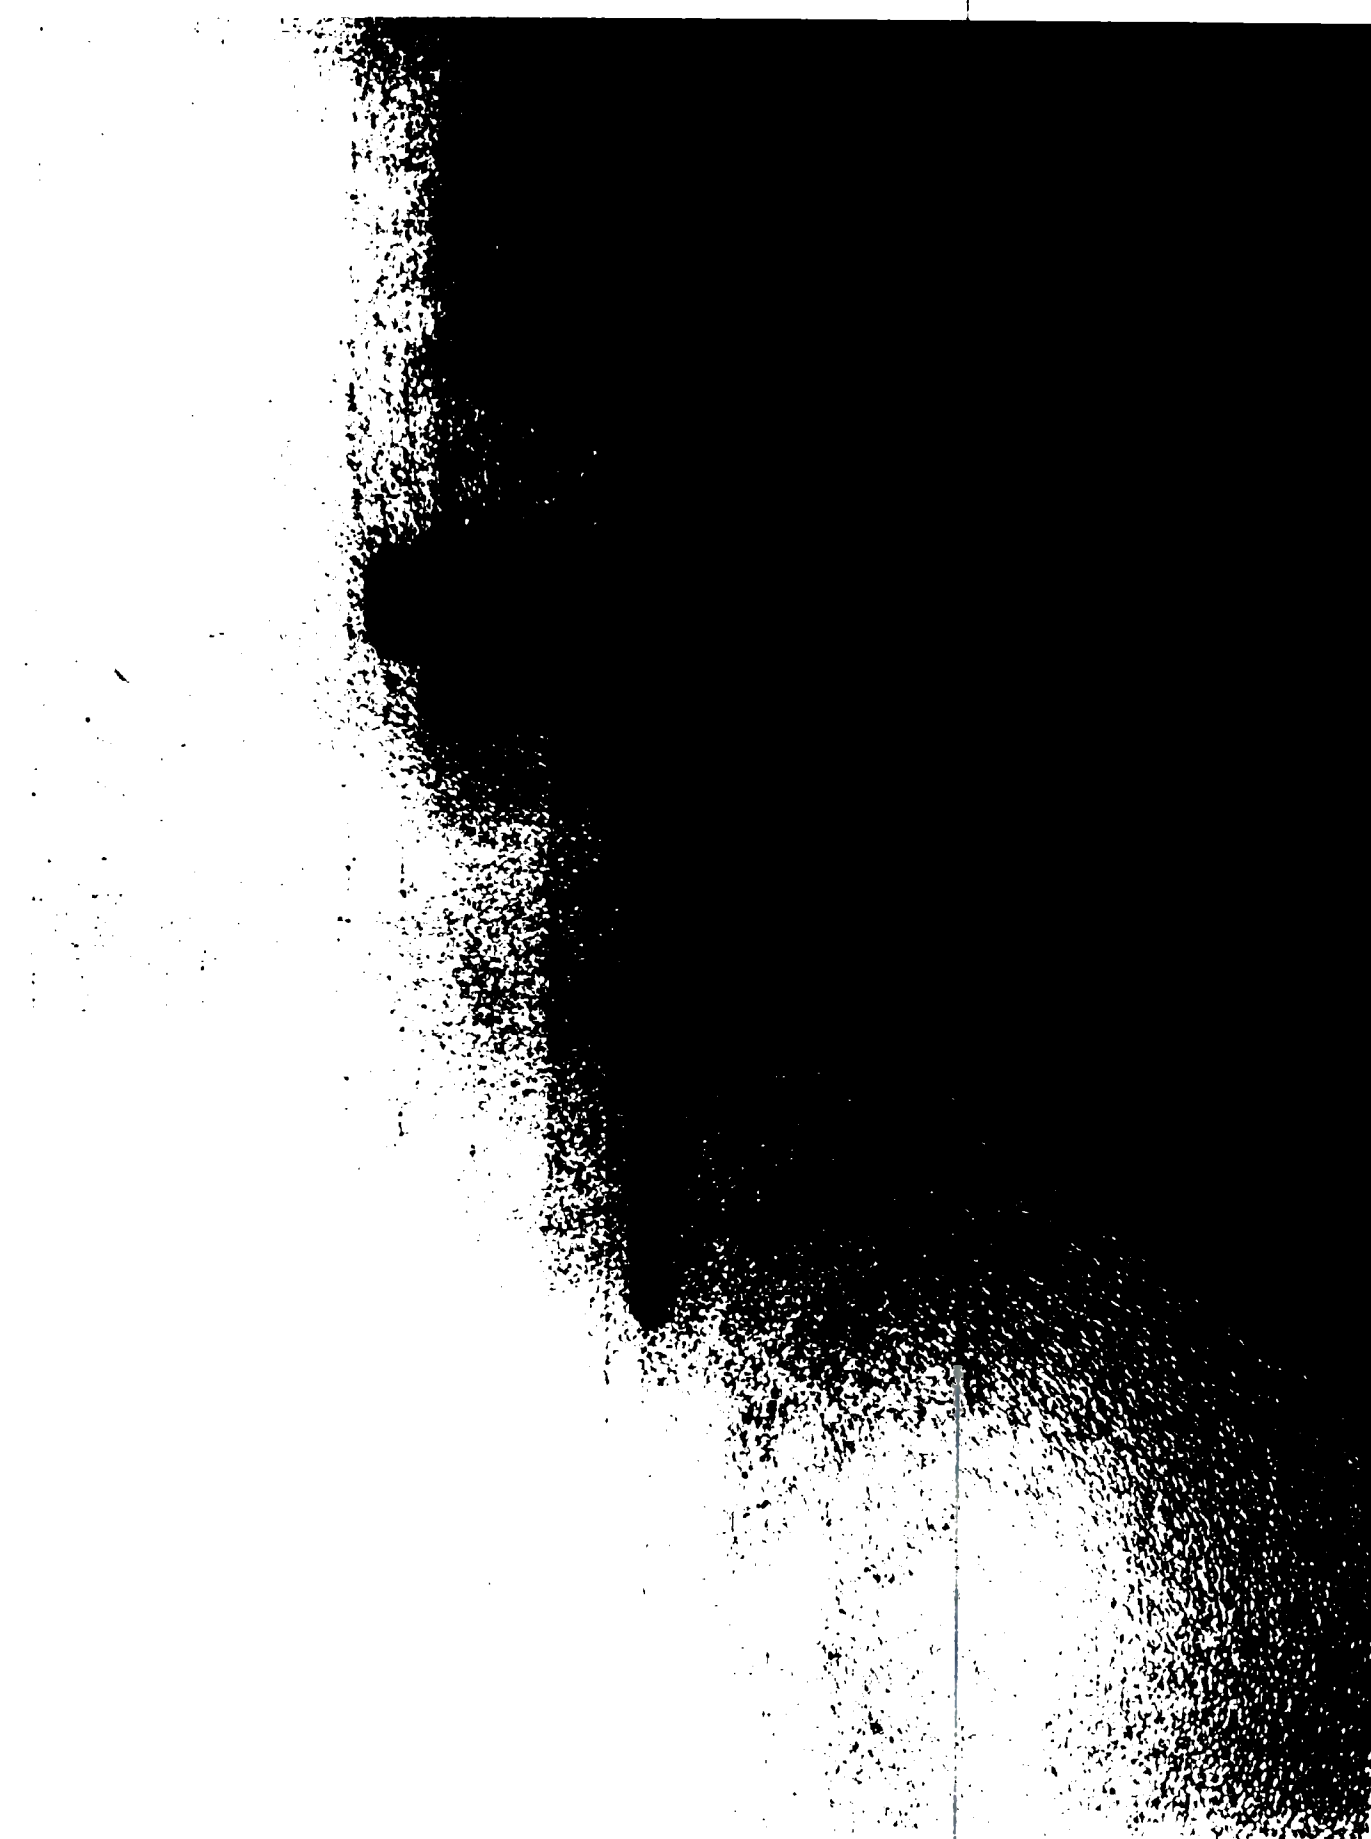

Упаковочный мандрен

Boston
Scientific

EXALT™ Model B

Single-Use Bronchoscope

Instructions for Use	3
Instrucciones de uso	13
Mode d'emploi	25
Gebrauchsanweisung	37
Istruzioni per l'uso	50
Instructies voor gebruik	62
Instruções de Utilização	75



2021 04

Инструкция по применению

**Boston
Scientific**

EXALT™ Model B

Бронхоскоп для одноразового применения EXALT Model B, средний, внешний диаметр 5,0 мм, средний внутренний диаметр рабочего канала 2,2 мм – коробка, сторона 1



Бронхоскоп для одноразового применения EXALT Model B, средний, внешний диаметр 5,0 мм, средний внутренний диаметр рабочего канала 2,2 мм – коробка, сторона 2



Бронхоскоп для одноразового применения EXALT Model B, средний, внешний диаметр 5,0 мм, средний внутренний диаметр рабочего канала 2,2 мм – маркировка коробки, сторона 2




Бронхоскоп для одноразового применения EXALT Model B, средний, внешний диаметр 5,0 мм, средний внутренний диаметр рабочего канала 2,2 мм – коробка, сторона 3



EXALT™ Model B

5.0mm

Бронхоскоп для одноразового применения EXALT Model B, средний, внешний диаметр 5,0 мм, средний внутренний диаметр рабочего канала 2,2 мм – коробка, сторона 4

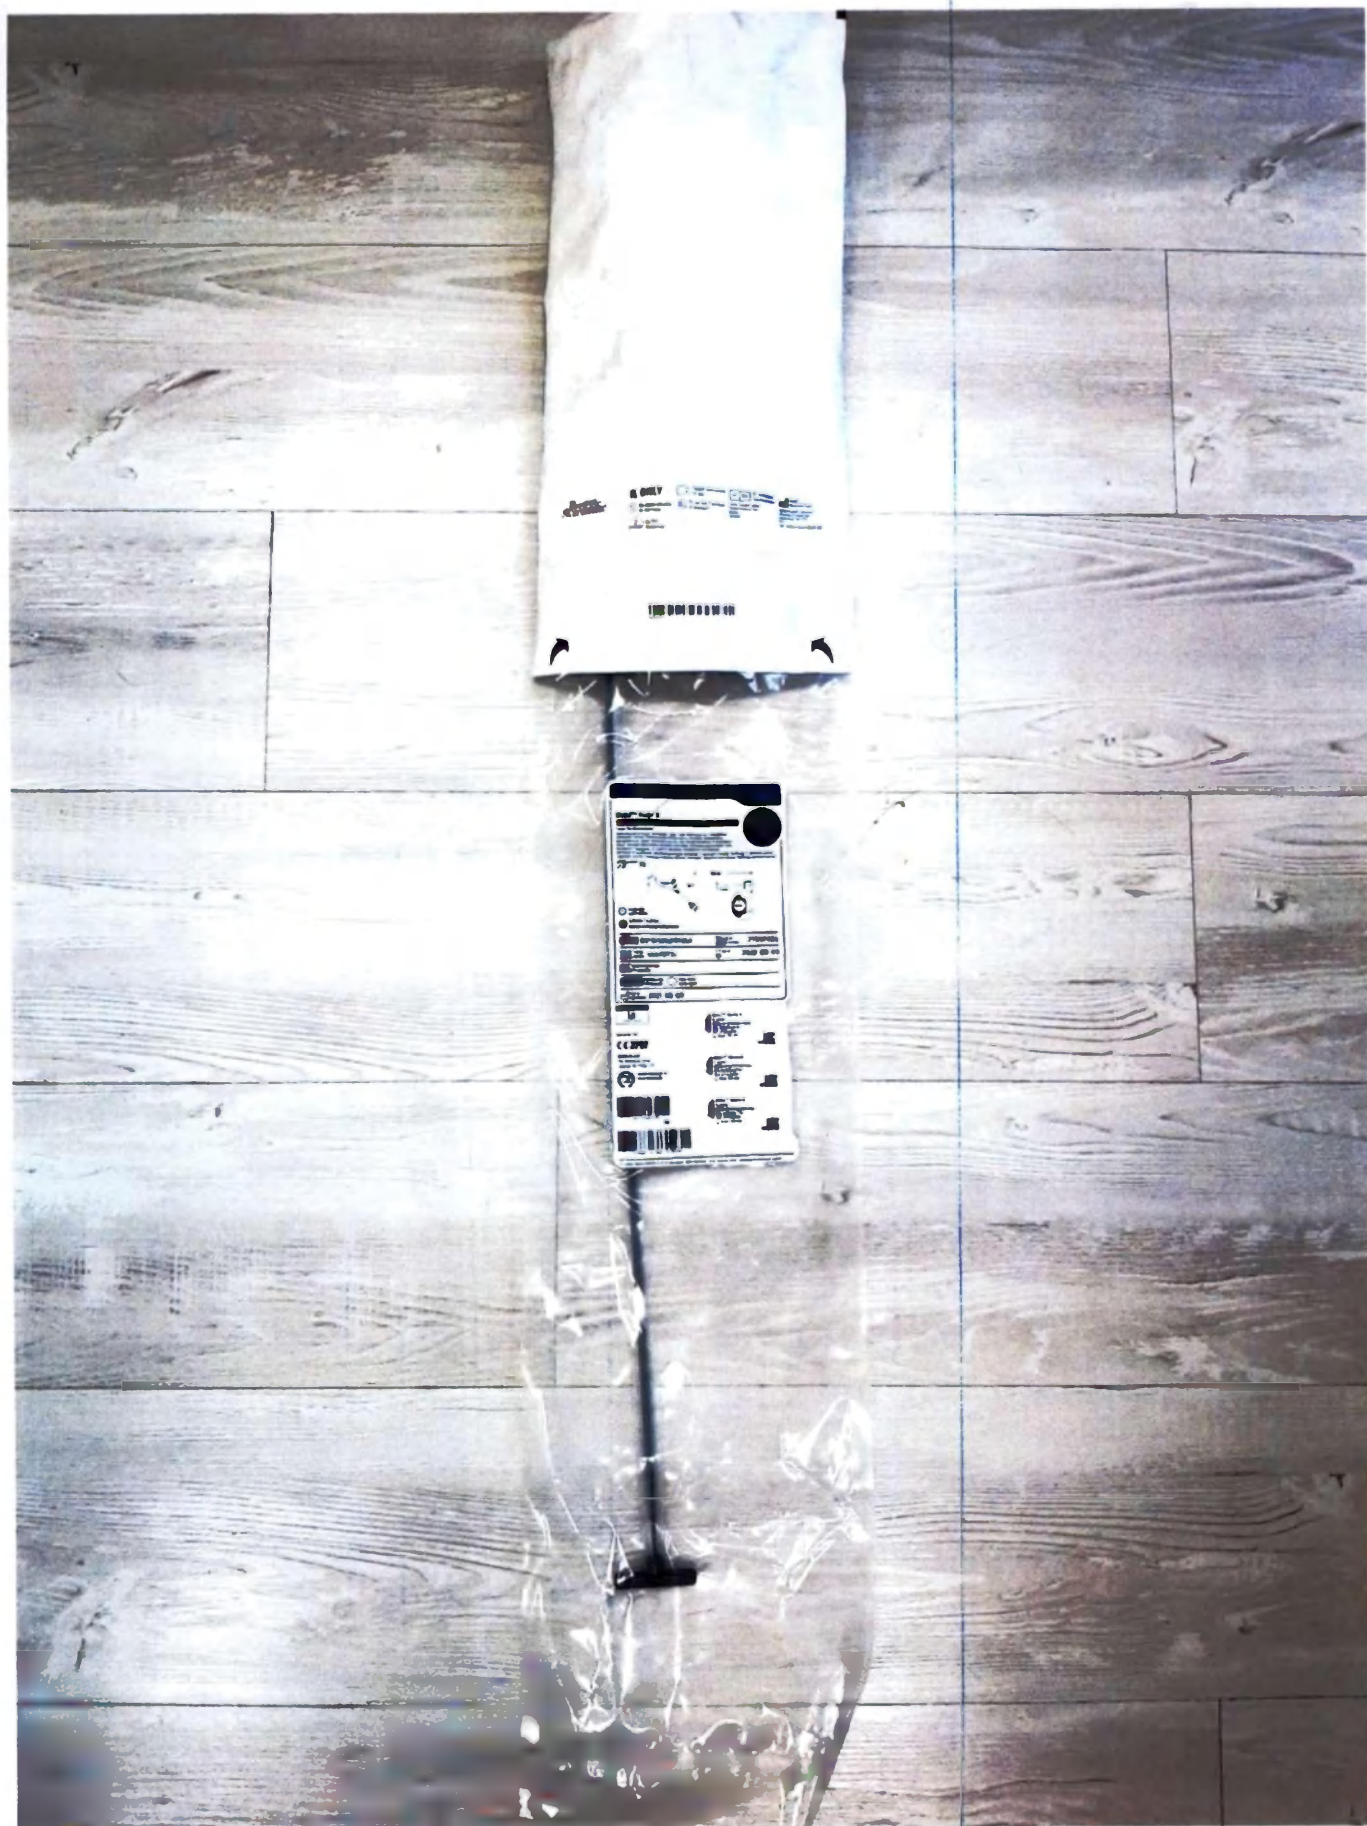

Бронхоскоп для одноразового применения EXALT Model B, средний, внешний диаметр 5,0 мм, средний внутренний диаметр рабочего канала 2,2 мм – Пакет, сторона 1



Бронхоскоп для одноразового применения EXALT Model B, средний, внешний диаметр 5,0 мм, средний внутренний диаметр рабочего канала 2,2 мм – Пакет, сторона 2

**Boston
Scientific**

EXALT™ Model B

Бронхоскоп для одноразового применения EXALT Model B, большой, внешний диаметр 5,8 мм.
средний внутренний диаметр рабочего канала 2,8 мм – коробка, сторона 1



Бронхоскоп для одноразового применения EXALT Model B, большой, внешний диаметр 5,8 мм, средний внутренний диаметр рабочего канала 2,8 мм – коробка, сторона 2

Boston
Scientific

EXALT™ Model B


LARGE

Single-Use Bronchoscope

Bronchoscope de un solo uso. Bronchoscope à usage unique.
Bronchoskop zum Einmalgebrauch. Bronchoscope monouso.
Bronchoscoop voor eenmalig gebruik. Bronchoskop til engangsbruk.
Бронхоскоп для однократного применения. Bronhoskopo para Uma Única Utilização.
Bronhoskop för engångsbruk. Egyszer használatos bronhoszkóp.
Jednorazový bronchoskop. Bronchoskop jednorazowego użytku.
Bronhoskop til engangsbruk. Tek Kullannatik Bronhoskop. Kertakäyttöinen bronhoskopi.
Bronhoskop de unică folosință. Jednorazový bronhoskop. Spowraczan za jednorazową użycie.
Bronhoskop za jednokratnu uporabu. Ühelandiselt kasutatav bronhoskoop. Viinrakajäs kätolatus
bronhoskops. Viinrakajäs bronhoskopas. Bronhoskop za enkratno uporabo

5.8mm
2.8mm

Contents (5)

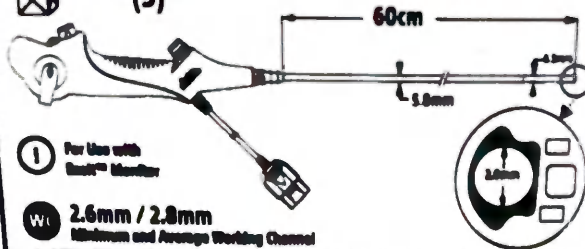

For Use with
Bios™ Monitor

2.6mm / 2.8mm
Minimum and Average Working Channel

GTIN

00191506007492

LOT Lot
Number

28595462

REF Catalog
Number

M00542751

Use By

2022-12-21

92554801-01A

CE 2797



Made in USA
750 Brookside Drive
Sparks, MD 21150 USA

EXALT™ Model B
5.8mm
GTIN 00191506007492
M00542751
28595462
2022-12-21

EXALT™ Model B
5.8mm
GTIN 00191506007492
M00542751
28595462
2022-12-21



EU Importer Boston Scientific International B.V., Vondelstraat 6, 0455 EX
Apeldoorn, The Netherlands


MD	Medical Device under EU Legislation
STERILE	Sterilized using ethylene oxide.
Date of Manufacture	2021-12-21

This product may be protected by one or more patents. Copyright information can be obtained at
http://www.boston-scientific.com/patents

Бронхоскоп для одноразового применения EXALT Model B, большой, внешний диаметр 5,8 мм, средний внутренний диаметр рабочего канала 2,8 мм – маркировка коробки, сторона 2



Бронхоскоп для одноразового применения EXALT Model B, большой, внешний диаметр 5,8 мм, средний внутренний диаметр рабочего канала 2,8 мм – коробка, сторона 3



EXALT™ Model B

5.8mm

Бронхоскоп для одноразового применения EXALT Model B, большой, внешний диаметр 5,8 мм, средний внутренний диаметр рабочего канала 2,8 мм – коробка, сторона 4



Бронхоскоп для одноразового применения EXALT Model B, большой, внешний диаметр 5,8 мм, средний внутренний диаметр рабочего канала 2,8 мм – Пакет, сторона 1

**Boston
Scientific**

Rx ONLY

For single use only
Do not reuse

Do Not
Reinsert



Consult instructions
for use



Do not use if package
is damaged



EC REP
EU Authorized
Representative



Legal Manufacturer
Boston Scientific Limited
Boston Scientific Park
Burlington, MA 01803
USA
©2021 Boston Scientific Corporation



EXALT™ Model B

Single Use Endoscope

Intended for use with an Endoscope Inspection System with Endoscope
Accessories. Endoscope is not to be used for any other purpose.
Endoscope is not to be used for any other purpose.
Endoscope is not to be used for any other purpose.
Endoscope is not to be used for any other purpose.
Endoscope is not to be used for any other purpose.

① Inspect (1)



① Inspect (1)

② 2.8mm / 1.1mm

③ 5.8mm / 2.3mm

④ 2.8mm / 1.1mm

⑤ 5.8mm / 2.3mm

⑥ 2.8mm / 1.1mm

⑦ 5.8mm / 2.3mm

⑧ 2.8mm / 1.1mm

⑨ 5.8mm / 2.3mm

⑩ 2.8mm / 1.1mm

⑪ 5.8mm / 2.3mm

⑫ 2.8mm / 1.1mm

⑬ 5.8mm / 2.3mm

⑭ 2.8mm / 1.1mm

⑮ 5.8mm / 2.3mm

⑯ 2.8mm / 1.1mm

⑰ 5.8mm / 2.3mm

⑱ 2.8mm / 1.1mm

⑲ 5.8mm / 2.3mm

⑳ 2.8mm / 1.1mm

㉑ 5.8mm / 2.3mm

㉒ 2.8mm / 1.1mm

㉓ 5.8mm / 2.3mm

㉔ 2.8mm / 1.1mm

㉕ 5.8mm / 2.3mm

㉖ 2.8mm / 1.1mm

㉗ 5.8mm / 2.3mm

㉘ 2.8mm / 1.1mm

㉙ 5.8mm / 2.3mm

㉚ 2.8mm / 1.1mm

㉛ 5.8mm / 2.3mm

㉜ 2.8mm / 1.1mm

㉝ 5.8mm / 2.3mm

㉞ 2.8mm / 1.1mm

㉟ 5.8mm / 2.3mm

㊱ 2.8mm / 1.1mm

㊲ 5.8mm / 2.3mm

㊳ 2.8mm / 1.1mm

㊴ 5.8mm / 2.3mm

㊵ 2.8mm / 1.1mm

㊶ 5.8mm / 2.3mm

㊷ 2.8mm / 1.1mm

㊸ 5.8mm / 2.3mm

㊹ 2.8mm / 1.1mm

㊺ 5.8mm / 2.3mm

CE 2797

Made in USA

700 Boulevard Saint
Exemple, St. Exemple, St. Exemple

St. Exemple, St. Exemple, St. Exemple

St. Exemple, St. Exemple, St. Exemple

St. Exemple, St. Exemple, St. Exemple

St. Exemple, St. Exemple, St. Exemple

St. Exemple, St. Exemple, St. Exemple

St. Exemple, St. Exemple, St. Exemple

St. Exemple, St. Exemple, St. Exemple

St. Exemple, St. Exemple, St. Exemple

St. Exemple, St. Exemple, St. Exemple

St. Exemple, St. Exemple, St. Exemple

St. Exemple, St. Exemple, St. Exemple

St. Exemple, St. Exemple, St. Exemple

St. Exemple, St. Exemple, St. Exemple

St. Exemple, St. Exemple, St. Exemple

St. Exemple, St. Exemple, St. Exemple

St. Exemple, St. Exemple, St. Exemple

St. Exemple, St. Exemple, St. Exemple

St. Exemple, St. Exemple, St. Exemple

St. Exemple, St. Exemple, St. Exemple

St. Exemple, St. Exemple, St. Exemple

St. Exemple, St. Exemple, St. Exemple

St. Exemple, St. Exemple, St. Exemple

St. Exemple, St. Exemple, St. Exemple

St. Exemple, St. Exemple, St. Exemple

St. Exemple, St. Exemple, St. Exemple

St. Exemple, St. Exemple, St. Exemple

St. Exemple, St. Exemple, St. Exemple

St. Exemple, St. Exemple, St. Exemple

St. Exemple, St. Exemple, St. Exemple

5.8mm
2.8mm

GTIN 00191306007485

28595462

480842750

2022-12-21

2021-12-21

2021-12-21

2021-12-21

2021-12-21

2021-12-21

2021-12-21

2021-12-21

2021-12-21

2021-12-21

2021-12-21

2021-12-21

2021-12-21

2021-12-21

2021-12-21

2021-12-21

2021-12-21

2021-12-21

2021-12-21

2021-12-21

2021-12-21

2021-12-21

2021-12-21

2021-12-21

2021-12-21

2021-12-21

2021-12-21

2021-12-21

2021-12-21

2021-12-21

2021-12-21

2021-12-21

2021-12-21

2021-12-21

2021-12-21

2021-12-21

2021-12-21

2021-12-21

2021-12-21

Бронхоскоп для одноразового применения EXALT Model B, большой, внешний диаметр 5,8 мм, средний внутренний диаметр рабочего канала 2,8 мм – маркировка пакета, сторона 1



Бронхоскоп для одноразового применения EXALT Model B, большой, внешний диаметр 5,8 мм, средний внутренний диаметр рабочего канала 2,8 мм – Пакет, сторона 2

ПРОШТО И
ПРОНУМЕРАВАНО
36 ЛИСТОВ

Генеральный директор
Шевчук Е.В.



МАКЕТЫ МАРКИРОВКИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Бронхоскоп для одноразового применения EXALT Model B, средний, внешний диаметр 5,0 мм, средний внутренний диаметр рабочего канала 2,2 мм – 5 шт.уп.

Регистрационное удостоверение:

От:

Нетоксично

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com.

Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкции по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Примечание: эти инструкции по применению регулярно обновляются. Наиболее актуальная версия доступна на вышеуказанном веб-сайте. Adobe® и Reader® являются товарными знаками компании Adobe Systems Incorporated.

Бронхоскоп для одноразового применения EXALT Model B, большой, внешний диаметр 5,8 мм, средний внутренний диаметр рабочего канала 2,8 мм – 5 шт.уп.

Регистрационное удостоверение:

От:

Нетоксично

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com.

Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкции по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Примечание: эти инструкции по применению регулярно обновляются. Наиболее актуальная версия доступна на вышеуказанном веб-сайте. Adobe® и Reader® являются товарными знаками компании Adobe Systems Incorporated.

ПРОШТО И
ПРОНУМЕРОВАНО
3 ЛИСТОВ

Генеральный директор
Шевчук Е.В.

