


«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «ИМБИАН ЛАБ»

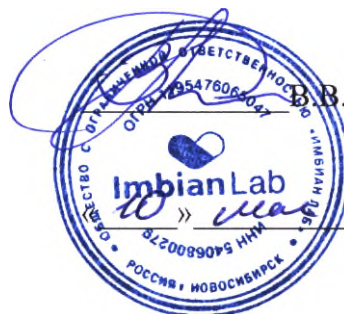

В.В.Осипова

2021 г.

**Набор реагентов для качественного выявления методом ПЦР in vitro ДНК
Streptococcus agalactiae в образцах ДНК, выделенных из клинических проб, с
детекцией в режиме реального времени «СтрептоБ-ИМБИАН-ПЦР» по ТУ 21.20.23-
148-41390295-2021**


Макет маркировки

2021

**СтрептоБ-
ИМБИАН-ПЦР**

Смесь для амплификации,
запечатанная парафином -
6 стрипов по 8 пробирок
(по 20 мкл.)


REF XX-XXX/X ГГГГ-ММ-ДД
LOT XXXXXX

**СтрептоБ-ИМБИАН-ПЦР**

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Тaq-полимераза - 500 мкл


REF XX-XXX/X
ГГГГ-ММ-ДД LOT XXXXXX

**СтрептоБ-ИМБИАН-ПЦР**

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Минеральное масло - 1,0 мл


REF XX-XXX/X
ГГГГ-ММ-ДД LOT XXXXXX

**СтрептоБ-ИМБИАН-ПЦР**

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Положительный контрольный образец - 130 мкл


REF XX-XXX/X
ГГГГ-ММ-ДД LOT XXXXXX

**СтрептоБ-
ИМБИАН-ПЦР**

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Крышки для стрипов - 6 шт

REF XX-XXX/X LOT XXXXXX
ГГГГ-ММ-ДД

**СтрептоБ-
ИМБИАН-ПЦР**

Комплект №1

Набор реагентов для качественного выявления методом ПЦР
in vitro ДНК *Streptococcus agalactiae* в образцах ДНК,
выделенных из клинических проб, с детекцией в режиме
реального времени «СтрептоБ-ИМБИАН-ПЦР» по
ТУ 21.20.23-115-41390295-2021



Набор содержит:

РУ № XXX XXXX/XXXXX


- | | |
|--|-------------------------|
| 1 Смесь для амплификации, запечатанная парафином (по 20 мкл) | 6 стрипов по 8 пробирок |
| 2 Таq-полимераза (500 мкл) | 1 пробирка |
| 3 Минеральное масло (1,0 мл) | 1 пробирка |
| 4 Положительный контрольный образец (130 мкл) | 1 пробирка |
| 5 Крышки для стрипов | 6 шт |
| 6 Вкладыш с информацией о контрольном образце | 1 шт |
| 7 Инструкция | 1 шт |

LOT XXXXXX
REF XX-XXX/X
ГГГГ-ММ-ДД
ГГГГ-ММ-ДД



ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Новосибирская область,
г. Новосибирск, рп. Кольцово,
ул. Садовая 2/7, помещение 2, этаж 2
8-800-600-90-77; 8(383)209-34-54.
info@imbian.ru

Готово к использованию
Только для диагностики in vitro. ТУ 21.20.23-115-41390295-2021
Для профессионального применения



**СтрептоБ-
ИМБИАН-ПЦР**

Смесь для амплификации,
запечатанная парафином -
48 пробирок (по 20 мкл.)

REF XX-XXX/X ГГГГ-ММ-ДД

LOT XXXXXX



+2°C



+8°C

**СтрептоБ-ИМБИАН-ПЦР**

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Тaq-полимераза - 500 мкл

REF XX-XXX/X

ГГГГ-ММ-ДД

LOT XXXXXX



+2°C

+8°C

**СтрептоБ-ИМБИАН-ПЦР**

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Минеральное масло - 1,0 мл

REF XX-XXX/X

ГГГГ-ММ-ДД

LOT XXXXXX



+2°C

**СтрептоБ-ИМБИАН-ПЦР**

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Положительный контрольный образец - 130 мкл

REF XX-XXX/X

ГГГГ-ММ-ДД

LOT XXXXXX



+2°C

**СтрептоБ-
ИМБИАН-ПЦР**

Комплект №2

Набор реагентов для качественного выявления методом ПЦР
in vitro ДНК Streptococcus agalactiae в образцах ДНК,
выделенных из клинических проб, с детекцией в режиме
реального времени «СтрептоБ-ИМБИАН-ПЦР» по
ТУ 21.20.23-115-41390295-2021

**Набор содержит:**

ПУ № XXX XXXX/XXXXX

- | | |
|--|-------------|
| 1 Смесь для амплификации, запечатанная парафином (по 20 мкл) | 48 пробирок |
| 2 Таq-полимераза (500 мкл) | 1 пробирка |
| 3 Минеральное масло (1,0 мл) | 1 пробирка |
| 4 Положительный контрольный образец (130 мкл) | 1 пробирка |
| 5 Вкладыш с информацией о контрольном образце | 1 шт |
| 6 Инструкция | 1 шт |



XXXXXX



XX-XXX/X



ГГГГ-ММ-ДД



ГГГГ-ММ-ДД



ООО «ИМБИАН ЛАБ»

630559, Новосибирская область,

г. Новосибирск, рп. Кольцово,

ул. Садовая 2/7, помещение 2, этаж 2

8-800-600-90-77, 8(383)209-34-54,

info@imbian.ru

Готово к использованию

Только для диагностики in vitro. ТУ 21.20.23-115-41390295-2021

Для профессионального применения



+2°C



+8°C



48



СтрептоБ-ИМБИАН-ПЦР


ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Смесь для амплификации - 600 мкл

REF XX-XXX/X

ГГГГ-ММ-ДД

LOT XXXXXX



СтрептоБ-ИМБИАН-ПЦР


ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Положительный контрольный образец - 130 мкл

REF XX-XXX/X

ГГГГ-ММ-ДД

LOT XXXXXX



СтрептоБ-ИМБИАН-ПЦР


ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Полимераза ТехноТаq МАХ - 30 мкл

REF XX-XXX/X

ГГГГ-ММ-ДД

LOT XXXXXX



СтрептоБ-ИМБИАН-ПЦР


ООО «ИМБИАН ЛАБ»

ПЦР-буфер - 600 мкл

REF XX-XXX/X

ГГГГ-ММ-ДД

LOT XXXXXX



СтрептоБ-ИМБИАН-ПЦР

Комплект №3

Набор реагентов для качественного выявления методом ПЦР in vitro ДНК Streptococcus agalactiae в образцах ДНК, выделенных из клинических проб, с детекцией в режиме реального времени «СтрептоБ-ИМБИАН-ПЦР» по ТУ 21.20.23-115-41390295-2021

Imbian

Набор содержит:

- 1 Смесь для амплификации (600 мкл)
- 2 Полимераза ТехноТаq МАХ (30 мкл)
- 3 ПЦР-буфер (600 мкл)
- 4 Положительный контрольный образец (130 мкл)
- 5 Вкладыш с информацией о контрольном образце
- 6 Инструкция

РУ № XXX XXXX/XXXXX

1 пробирка

LOT XXXXXX

1 пробирка

REF XX-XXX/X

1 пробирка



ГГГГ-ММ-ДД

1 шт

ГГГГ-ММ-ДД

1 шт

Полимеразу ТехноТаq МАХ следует хранить в морозильной камере при температуре от минус 18°C до минус 22°C в течении всего срока годности набора



Готово к использованию
Только для диагностики in vitro.
ТУ 21.20.23-115-41390295-2021
Для профессионального применения

ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Новосибирская область,
г. Новосибирск, рп. Кольцово,
ул. Садовая 2/7, помещение 2, этаж 2
8-800-600-90-77; 8(383)209-34-54,
info@imbian.ru

МАРКИРОВКА ГРУППОВОЙ УПАКОВКИ (ТРАНСПОРТ)

СтрептоБ-ИМБИАН-ПЦР

Набор реагентов для качественного выявления методом ПЦР in vitro ДНК Streptococcus agalactiae в образцах ДНК, выделенных из клинических проб, с детекцией в режиме реального времени «СтрептоБ-ИМБИАН-ПЦР» по ТУ 21.20.23-115-41390295-2021

РУ № XXX XXXX/XXXXX
ТУ 21.20.23-115-41390295-2021

Комплект 1 (стрипы)/Комплект 2 (пробирки)/
Комплект 3 - нужное подчеркнуть

Количество
наборов

ШТ

Масса нетто

кг








Масса брутто

кг

LOT XXXXXX ГГГГ-ММ-ДД

REF XX-XXX/X ГГГГ-ММ-ДД

Замораживать не допускается
Допустима транспортировка при температуре от +2 до +8°C



Imbian

ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Новосибирская область,
г. Новосибирск, рп. Кольцово,
ул. Садовая 2/7, помещение 2, этаж 2
8-800-600-90-77; 8(383)209-34-54,
info@imbian.ru

Генеральный директор ООО «ИМБИАН ЛАБ»

В.В. Осипова

Сшито и заверено печатью 4
(Имбире) листа а



Генеральный директор ООО «Имбиан лаб»
Осипова В.В.

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «ИМБИАН ЛАБ»




Фотографические изображения общего вида

Набор реагентов для качественного выявления методом ПЦР in vitro ДНК Streptococcus agalactiae в образцах ДНК, выделенных из клинических проб, с детекцией в режиме реального времени «СтрептоБ-ИМБИАН-ПЦР» по ТУ 21.20.23-148-41390295-2021

Комплект № 1 (стрипы):

Смесь для амплификации, запечатанная парафином (по 20 мкл);

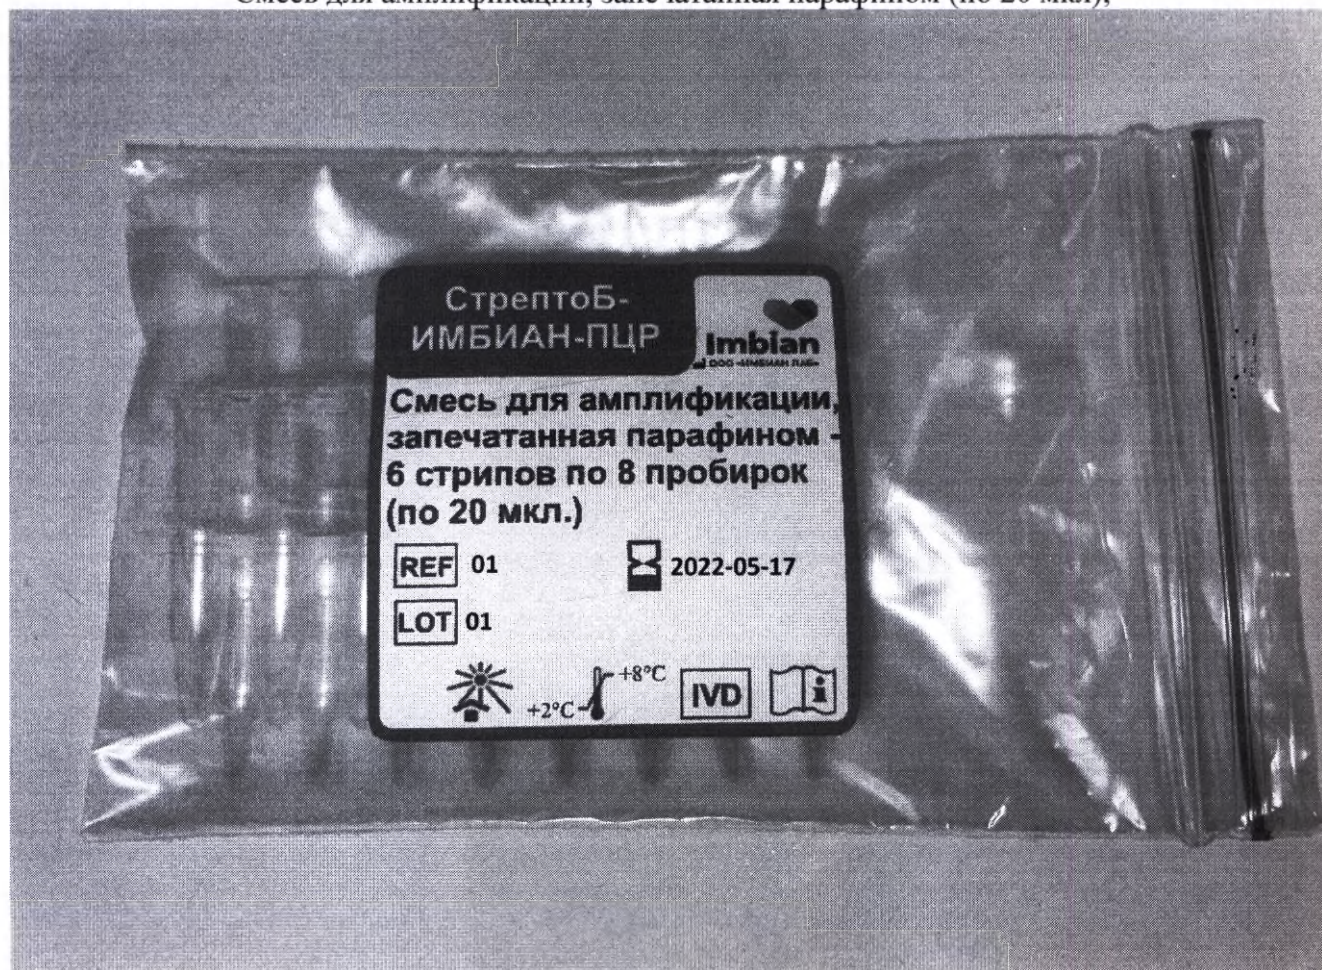

Тaq-полимераза (500 мкл);




Минеральное масло (1,0 мл);




Положительный контрольный образец (130 мкл);



Крышки для стрипов;

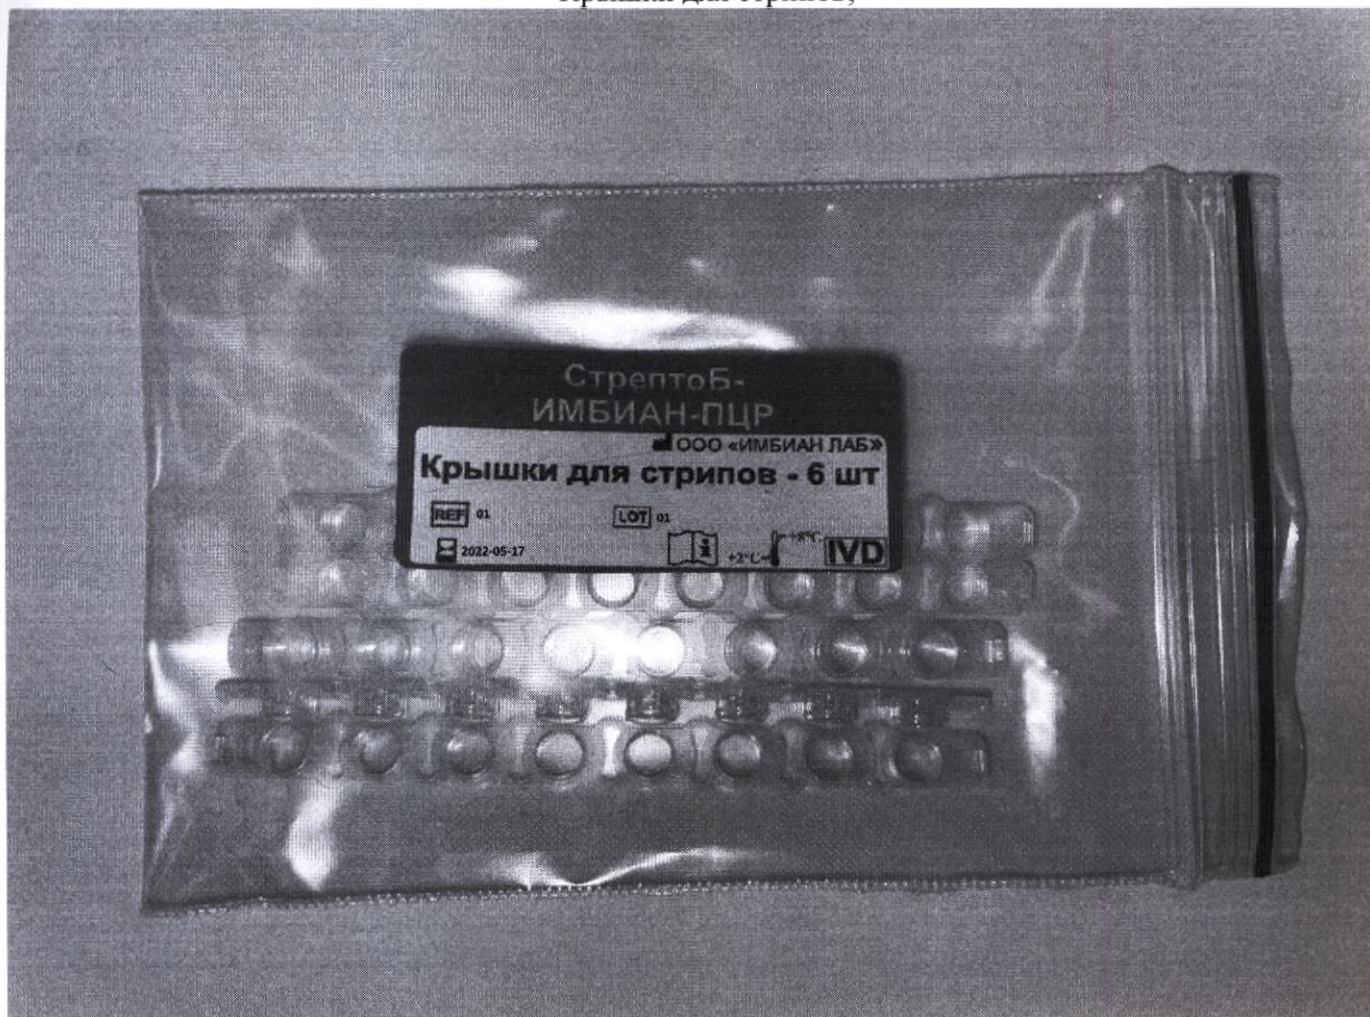

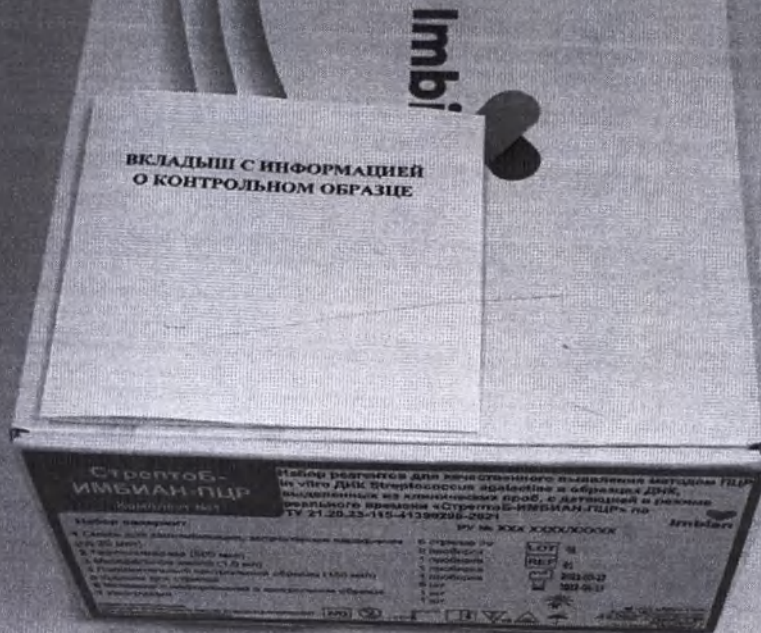

Инструкция по применению
Набор реагентов для качественного
выявления методом ПЦР in vitro
ДНК Streptococcus agalactiae в
образцах ДНК,
выделенных из клинических проб, с
детекцией
в режиме реального времени
«СтрептоБ-ИМБИАН-ПЦР»
по ТУ 21.20.23-148-41390295-2021

СтрептоБ-ИМБИАН-ПЦР

Комплект №1

Набор реагентов для качественного выявления методом ПЦР in vitro ДНК *Streptococcus agalactiae* в образцах ДНК, выделенных из клинических проб, с детекцией в режиме реального времени «СтрептоБ-ИМБИАН-ПЦР» по ТУ 21.20.23-115-41390295-2021

Imbian

Набор содержит:

РУ № XXX XXXX/XXXXX

- 1 Смесь для амплификации, запечатанная парафином (по 20 мкл)
- 2 Таq-полимераза (500 мкл)
- 3 Минеральное масло (1,0 мл)
- 4 Положительный контрольный образец (130 мкл)
- 5 Крышки для стрипов
- 6 Вкладыш с информацией о контрольном образце
- 7 Инструкция

- 6 стрипов по 8 пробирок
- 1 пробирка
- 1 пробирка
- 1 пробирка
- 6 шт
- 1 шт
- 1 шт

LOT 01

REF 01

2021-05-17

2022-05-17

Только к использованию
Только для диагностики in vitro. ТУ 21.20.23-115-41390295-2021
Для профессионального применения

IVD

2

+2°C

+K°C

48

48

48

48

48

48

48

48

48

48

48

48

48


ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Новосибирская обл.,
ГО Рабочий поселок Колыцово,
РП Колыцово, ул. Садовая, д. 2/7,
этаж 2, пом. 2
8-800-600-80-77, info@imbiana.ru

Комплект № 2 (пробирки):

Смесь для амплификации, запечатанная парафином (по 20 мкл);



Тaq-полимераза (500 мкл);

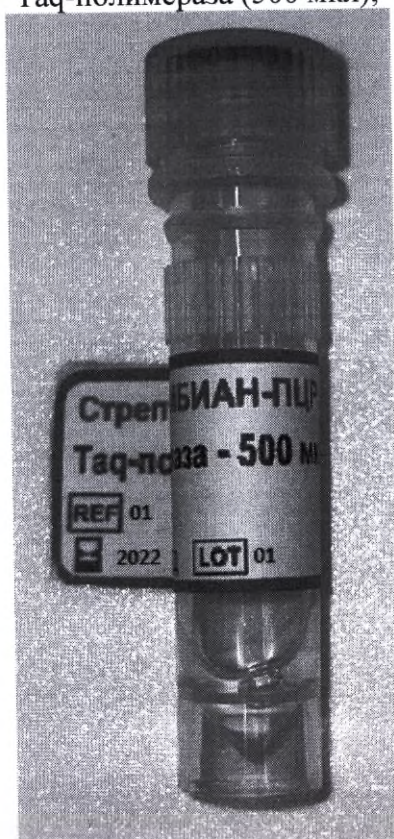

Минеральное масло (1,0 мл);



Положительный контрольный образец (130 мкл);



СтрептоБ- ИМБИАН-ПЦР

Комплект №2

Набор реагентов для качественного выявления методом ПЦР
in vitro ДНК *Streptococcus agalactiae* в образцах ДНК,
выделенных из клинических проб, с детекцией в режиме
реального времени «СтрептоБ-ИМБИАН-ПЦР» по
ТУ 21.20.23-115-41390295-2021

Imbian

Набор содержит:

РУ № XXX XXXX/XXXXX

- | | |
|--|-------------|
| 1 Смесь для амплификации, запечатанная парафином (по 20 мкл) | 48 пробирок |
| 2 Taq-полимераза (500 мкл) | 1 пробирка |
| 3 Минеральное масло (1,0 мл) | 1 пробирка |
| 4 Положительный контрольный образец (130 мкл) | 1 пробирка |
| 5 Вкладыш с информацией о контрольном образце | 1 шт |
| 6 Инструкция | 1 шт |

LOT 01

REF 01

2021-05-17

2022-05-17

Готовые к использованию
Только для диагностики in vitro. ТУ 21.20.23-115-41390295-2021
Для профессионального применения



ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630090, Новосибирская обл.
Г.О. Ребриный поселок Колызово,
РП Колызово, ул. Садовая, д. 27/
этаж 2, комната 2
8-800-600-90-77, info@imbian.ru

Комплект № 3:

Смесь для амплификации (600 мкл);



Полимераза ТехноТaq МАХ (30 мкл);



ПЦР-буфер (600 мкл);




Положительный контрольный образец (130 мкл);





Инструкция по применению
Набор реактивов для качественного выявления методом ПЦР in vitro ДНК *Streptococcus agalactiae* в образцах ДНК, выделенных из клинических проб, с детекцией в режиме реального времени «СтрептоБ-ИМБИАН-ПЦР» по ТУ 21.20.23-148-41390295-2021

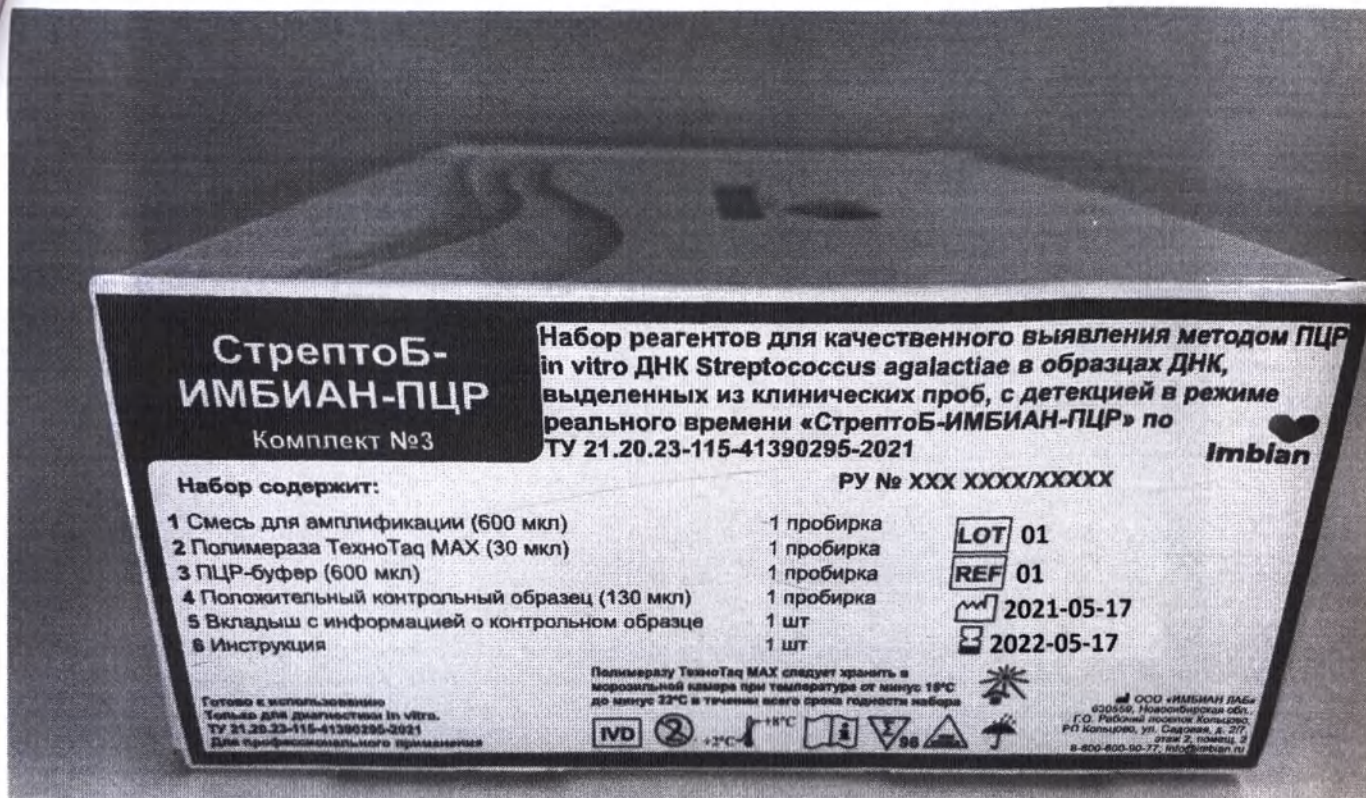

Транспортная упаковка



Генеральный директор ООО «ИМБИАН ЛАБ»



Сшито и заверено печатью 141
Создана лист 03

Генеральный директор ООО «Имбиан лаб»
Осипова В.В.

