


Фотоизображения

Набор реагентов для выделения и качественного выявления РНК
коронавируса SARS-CoV-2 методом полимеразной цепной реакции в реальном
времени «MAG-SARS-CoV-2-ИМБИАН-ПЦР», ТУ 21.20.23-106-41390295-2021

Комплект №1, Серия 211018

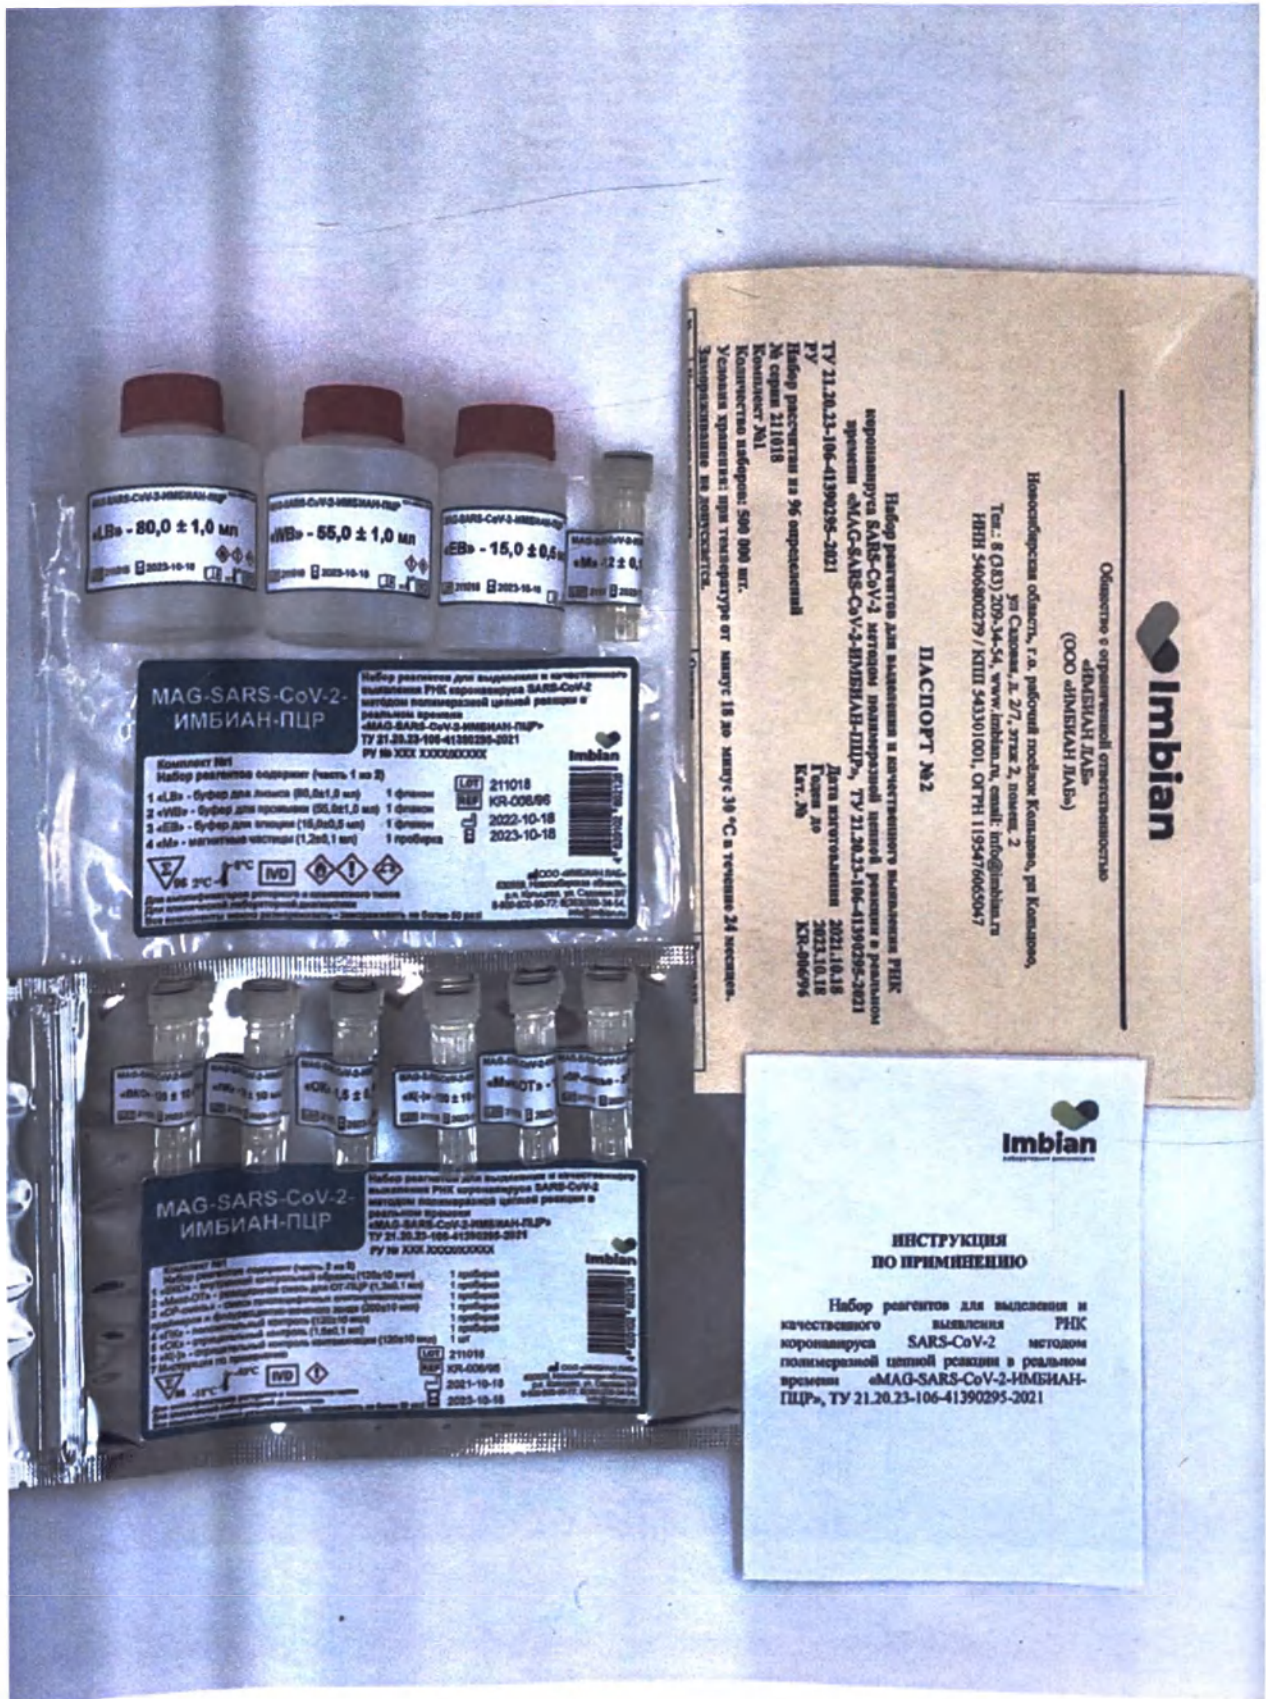

MAG-SARS-CoV-2-ИМБИАН-ПЦР

Набор реагентов для выделения и качественного выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 методом полимеразной цепной реакции в реальном времени
«MAG-SARS-CoV-2-ИМБИАН-ПЦР»
ТУ 21.20.23-106-41390295-2021
РУ № XXX XXXX/XXXXXX

Комплект №1

Набор реагентов содержит (часть 1 из 2)

- | | |
|---|------------|
| 1 «LB» - буфер для лизиса (80,0±1,0 мл) | 1 флакон |
| 2 «WB» - буфер для промывки (55,0±1,0 мл) | 1 флакон |
| 3 «EB» - буфер для элюции (15,0±0,5 мл) | 1 флакон |
| 4 «M» - магнитные частицы (1,2±0,1 мл) | 1 пробирка |

LOT 211018
REF KR-006/96
2022-10-18
2023-10-18

Imbian



Для амплификаторов роторного и планшетного типов
Для клинической лабораторной диагностики
Все компоненты можно размораживать - замораживать не более 50 раз!

ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Новосибирская область,
г.п. Колывань, ул. Саянская 2/7
8-800-800-80-77; 8(383)209-34-54,
info@imbian.ru

MAG-SARS-CoV-2-ИМБИАН-ПЦР
«M» - 1,2 ± 0,1
LOT 211018 2023

MAG-SARS-CoV-2-ИМБИАН-ПЦР
«LB» - 80,0 ± 1,0 мл
LOT 211018 2023-10-18

MAG-SARS-CoV-2-ИМБИАН-ПЦР
«WB» - 55,0 ± 1,0 мл
LOT 211018 2023-10-18

MAG-SARS-CoV-2-ИМБИАН-ПЦР
«EB» - 15,0 ± 0,5 мл
LOT 211018 2023-10-18



Комплект №2, Серия 211020

Imbian

Общество с ограниченной ответственностью
«ИМБИАН ЛАБО»
(ООО «ИМБИАН ЛАБО»)

Новосибирская область, г.о. рабочий посёлок Колызово, рп. Колызово,
ул. Савина, д. 27, этаж 2, помещ. 2
Тел.: 8 (383) 306-34-54, www.imbian.ru, email: info@imbian.ru
ИНН 5406080279 / КПП 540301001, ОГРН 1195476065047

ПАСПОРТ №3

Набор реагентов для выделения и качественного выявления РНК
коронавируса SARS-CoV-2 методом полимеразной цепной реакции в реальном
времени «MAG-SARS-CoV-2-ИМБИАН-ПЦР», ТУ 21.20.23-106-41390295-2021

ТУ 21.20.23-106-41390295-2021
Дата изготовления 2023-10-20
Годен до 2023-10-20
Кат. № КВ-006/96

Набор реагентов на 96 определений

Масса нетто 500 000 мг.

Условия хранения при температуре от минус 18 до минус 30 °С в течение 24 месяцев.

Замораживание не допускается.

Масса нетто 500 000 мг.

Условия хранения при температуре от минус 18 до минус 30 °С в течение 24 месяцев.

Замораживание не допускается.

MAG-SARS-CoV-2-ИМБИАН-ПЦР

- Комплект №2
Набор реагентов стандарт (часть 1 из 2)
- 1 «LB» - буфер для лизиса (80,0 ± 1,0 мл) 1 флакон
 - 2 «WB» - буфер для промывки (55,0 ± 1,0 мл) 1 флакон
 - 3 «EB» - буфер для элиции (15,0 ± 0,5 мл) 1 флакон
 - 4 «AB» - капиллярная чашка (1,2 мл, 1 шт) 1 пробирка

Набор реагентов для выделения и качественного выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «MAG-SARS-CoV-2-ИМБИАН-ПЦР», ТУ 21.20.23-106-41390295-2021
РР № XXX XXXXXXXXX

LOT 211020
KR-006/96.1
2021-10-20
2023-10-20

«ООО «ИМБИАН ЛАБО»
650023, Новосибирская область,
г.о. рабочий посёлок Колызово, рп. Колызово, ул. Савина, д. 27,
этаж 2, помещ. 2
8-800-400-60-77, 8-400-000-00-00

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Набор реагентов для выделения и качественного выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «MAG-SARS-CoV-2-ИМБИАН-ПЦР», ТУ 21.20.23-106-41390295-2021

MAG-SARS-CoV-2-ИМБИАН-ПЦР

«PC» - 1 микропластикет

LOT 211020 2023-10-20

MAG-SARS-CoV-2-ИМБИАН-ПЦР

«PC» - 1 микропластикет

LOT 211020 2023-10-20

MAG-SARS-CoV-2- ИМБИАН-ПЦР

Набор реактивов для выявления и количественного
выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2
методом полимеразной цепной реакции в
реальном времени

«MAG-SARS-CoV-2-ИМБИАН-ПЦР»

ТУ 21.20.23-106-4130028-2021

Р/У № XXX XXXX/XXXX



Imbiyan

Комплект №2

Набор реактивов содержит (часть 1 из 2)

- 1 «LB» - буфер для лизиса (80,0±1,0 мл)
- 2 «WB» - буфер для промывки (55,0±1,0 мл)
- 3 «EB» - буфер для амплиции (15,0±0,5 мл)
- 4 «MA» - матричные участки (1,2±0,1 мг)

- 1 флакон
- 1 флакон
- 1 флакон
- 1 пробирка

LOT 211020

REF KR-008/86.1

2021-10-20

2023-10-20



Для использования реактивов требуется соблюдение правил личной безопасности
при работе с биологическими материалами. При работе с реактивами необходимо соблюдать меры безопасности, указанные на этикетке.


ООО «ИМБИАН ПЦР»
г.п.п. Бразилья, м. Сауле 2/7
8-800-400-80-77, 8-800-200-54-54,
info@imbiyan.ru

MAG-SARS-CoV-2-IMBIAN-PCR
«MA» - 1,2 ± 0,1
LOT 211020 B 2021

MAG-SARS-CoV-2-IMBIAN-PCR
«LB» - 80,0 ± 1,0 мл
LOT 211020 B 2023-10-20

MAG-SARS-CoV-2-IMBIAN-PCR
«WB» - 55,0 ± 1,0 мл
LOT 211020 B 2023-10-20

MAG-SARS-CoV-2-IMBIAN-PCR
«EB» - 15,0 ± 0,5 мл
LOT 211020 B 2023-10-20

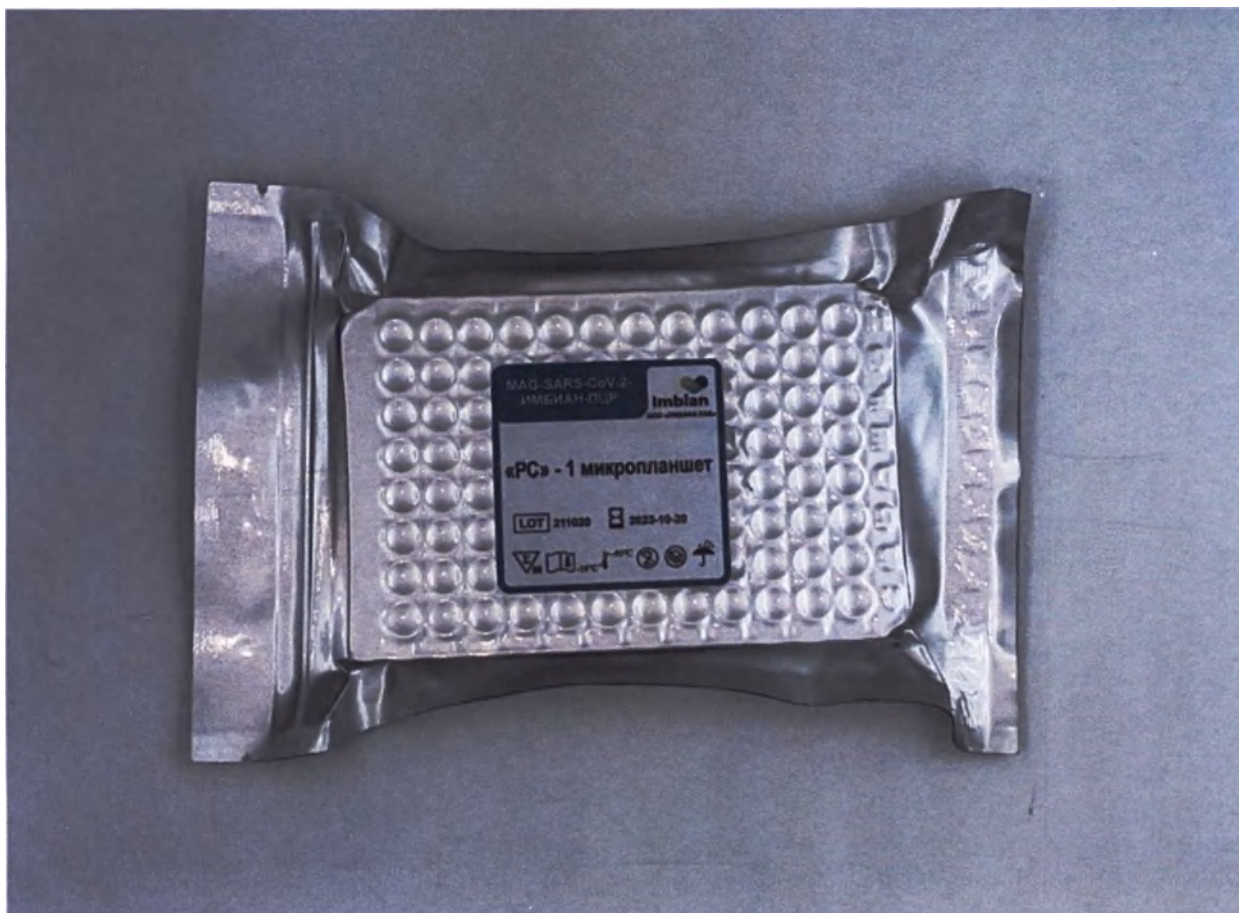

Генеральный директор ООО «ИМБИАН ЛАБ»

В.В. Осипова

«10» 10 2022 г.



Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

6 лист 18
Генеральный директор
ООО «ИМБИАН ЛАБ»
В.В. Осипова
"20" 12 2022 г.

