

Макеты этикеток на медицинское изделие для диагностики *in vitro*
«Набор реагентов для калибровки
«MagnoLIA антиТГ», по ТУ 21.20.23-576-98539446-2021»,
производства ООО «Компания Алкор Био»

Генеральный директор
ООО «Компания Алкор Био»



Полынцев Д.Г.

Вариант исполнения 1

Кат. № 1120101

На коробку:



Набор реагентов для калибровки
 «MagnaLIA антиТГ»,
 по ТУ 21.20.23-576-98539446-2021

Состав набора:

Калибратор 1	1 фл.
Калибратор 2	1 фл.
Калибратор 3	1 фл.
Калибратор 4	1 фл.

Готово к использованию.
 Для профессионального применения.
 Антитела к ВИЧ 1, 2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют




ТУ 21.20.23-576-98539446-2021
 РУ №XXXXXXXXXXXXXX

ООО «Компания Алкор Био»,
 192148, Россия, г. Санкт-Петербург,
 Железнодорожный пр., д. 40, лит А
 Тел: +7 (812) 778779; 6772162
 www.alkorbio.ru

На флаконы:

MagnaLIA
 антиТГ
 Калибратор 1
 объем 1,0 мл
 +25°C
 000 «Компания Алкор Био»




MagnaLIA
 антиТГ
 Калибратор 2
 объем 0,5 мл
 +25°C
 000 «Компания Алкор Био»



MagnaLIA
 антиТГ
 Калибратор 3
 объем 0,5 мл
 +25°C
 000 «Компания Алкор Био»



MagnaLIA
 антиТГ
 Калибратор 4
 объем 1,0 мл
 +25°C
 000 «Компания Алкор Био»



Набор реагентов для калибровки «MagnaLIA антиТГ»

Макет этикеток

ГРУППА КОМПАНИЙ
АЛКОР-БИО

Вариант исполнения 2

Кат. № 1120105

На коробку:

MagnaLIA

Состав набора:

Калибратор 1	5 фл.
Калибратор 2	5 фл.
Калибратор 3	5 фл.
Калибратор 4	5 фл.

ТУ 21.20.23-576-98539446-2021
ПУ № XXXXXXXXXXXXXXXX

ООО «Компани Алкор Био»
187144, Россия, г. Санкт-Петербург,
Жуковский район, д. 44, лит. А
тел. факс: +7 (812) 571 71 71, 571 72 02
info@alcorbio.ru, www.alcorbio.ru

MagnaLIA антиТГ

LOT E005
REF 1120105
IVD

2022-07-21

+2⁺8
°C

50

Биологическая опасность

Информация

Предупреждение

Набор реагентов для калибровки
«MagnaLIA антиТГ», по ТУ 21.20.23-576-98539446-2021

LOT E005

2021-07-21

+2⁺8
°C



REF 1120105

2022-07-21



IVD

50



Готово к использованию.
Для профессионального применения.
Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют.

На флаконы:

MagnaLIA
антиТГ

Калибратор 1
объем 1,0 мл

+2⁺8
°C

ООО «Компани Алкор Био»



- 5 мм

MagnaLIA
антиТГ

Калибратор 2
объем 0,5 мл

+2⁺8
°C

ООО «Компани Алкор Био»



- 5 мм

MagnaLIA
антиТГ

Калибратор 3
объем 0,5 мл

+2⁺8
°C

ООО «Компани Алкор Био»



- 5 мм

MagnaLIA
антиТГ

Калибратор 4
объем 1,0 мл

+2⁺8
°C

ООО «Компани Алкор Био»



- 5 мм

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью

3 (три) лист 1

Генеральный директор

ООО «Компания Алкор Био»

Д.И. Голынец



Фотографии медицинского изделия

Медицинское изделие для диагностики in vitro «Набор реагентов для калибровки «MagnoLIA антиТГ», производства ООО «Компания Алкор Био»

Вариант исполнения 1	стр. 2,3,4
Вариант исполнения 2	стр. 5,6,7
Калибраторы 1,2,3,4	стр. 8,9,10,11

**Генеральный директор
ООО «Компания Алкор Био»**



Полынцев Д.Г.

ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E005

Набор реагентов для калибровки

«MagnaLIA антиТГ», по ТУ 21.20.23-576-98539446-2021

Кат. № 1120101 Серия № E005 Формирование № 1 Количество 100 шт.



MagnaLIA

Набор реагентов для калибровки
«MagnaLIA антиТГ»,
по ТУ 21.20.23-576-98539446-2021

Состав набора:

Калибратор 1	1 фл.
Калибратор 2	1 фл.
Калибратор 3	1 фл.
Калибратор 4	1 фл.

Готово к использованию.
Для профессионального применения.
Антитела к ВПЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Медицинского изделия для диагностики in vitro

«Набор реагентов для калибровки «MagnaLIA антиТГ»,

по ТУ 21.20.23-576-98539446-2021


ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E005

Набор реагентов для калибровки

«MagnoLIA антиТТ», по ТУ 21.20.23-576-98539446-2021

Кат. № 1120101 Серия № E005 Формирование № 1 Количество 100 шт.

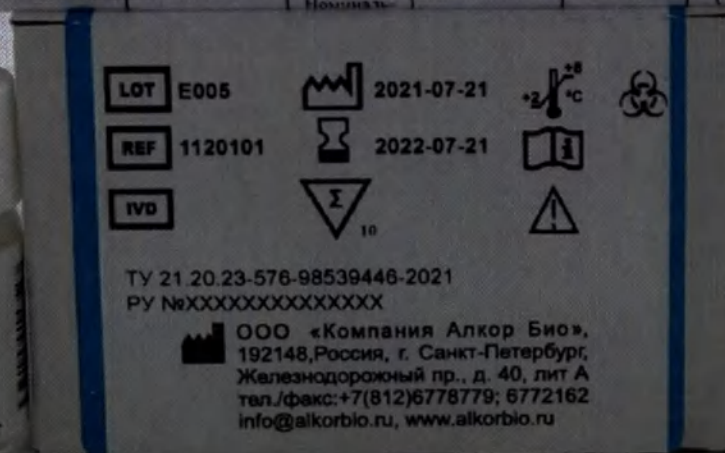



ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E005

Набор реагентов для калибровки

«MagnaLIA антиТГ», по ТУ 21.20.23-576-98539446-2021

Кат. № 1120101 Серия № E005 Формирование № 1 Количество 100 шт.

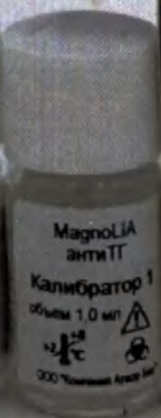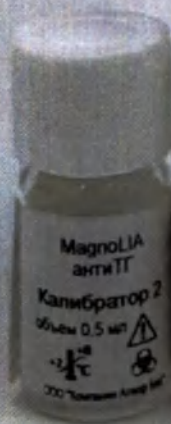

ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E005

Набор реагентов для калибровки

«MagnaLIA антиТГ», по ТУ 21.20.23-576-98539446-2021

Кат. № 1120105 Серия № E005 Формирование № 1 Количество 100 шт.



Набор реагентов для калибровки
«MagnaLIA антиТГ», по ТУ 21.20.23-576-98539446-2021

Состав набора:

Калибратор 1	5 фл.
Калибратор 2	5 фл.
Калибратор 3	5 фл.
Калибратор 4	5 фл.

LOT E005

2021-07-21

+2°C



REF 1120105

2022-07-21



IVD




ТУ 21.20.23-576-98539446-2021
РУ № XXXXXXXXXX

Готово к использованию.
Для профессионального применения.
Антигена к ВМЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствует.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Медицинского изделия для диагностики *in vitro*
«Набор реагентов для калибровки «MagnaLIA антиТГ»,
по ТУ 21.20.23-576-98539446-2021

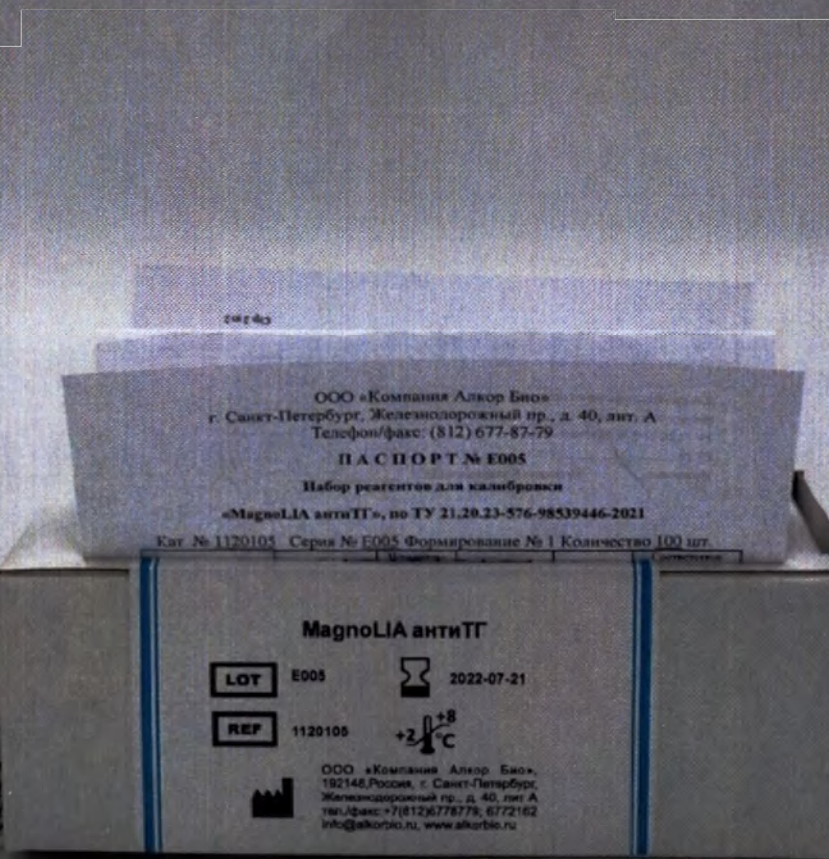







MagnoLIA
антиТГ

Калибратор 2

объем 0,5 мл

+8
+3/°C



ООО "Компания Алкор Био"



MagnoLIA
антиТТ

Калибратор 3

объем 0,5 мл



+8
+2°C



ООО "Компания Алкор Био"




MagnoLIA
антиТГ

Калибратор 4

объем 1,0 мл

+8
+3/5°C



ООО "Компания Алкор Био"

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью

1 (001101000000) лист 10

Генеральный директор

ООО «Компания Алкор Био»

Д.Е. Полинцев

