


Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
 “Антипаллидум-суммарные антитела-Люминит”
 серия 1

Генеральный директор
 АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
 2021 г.

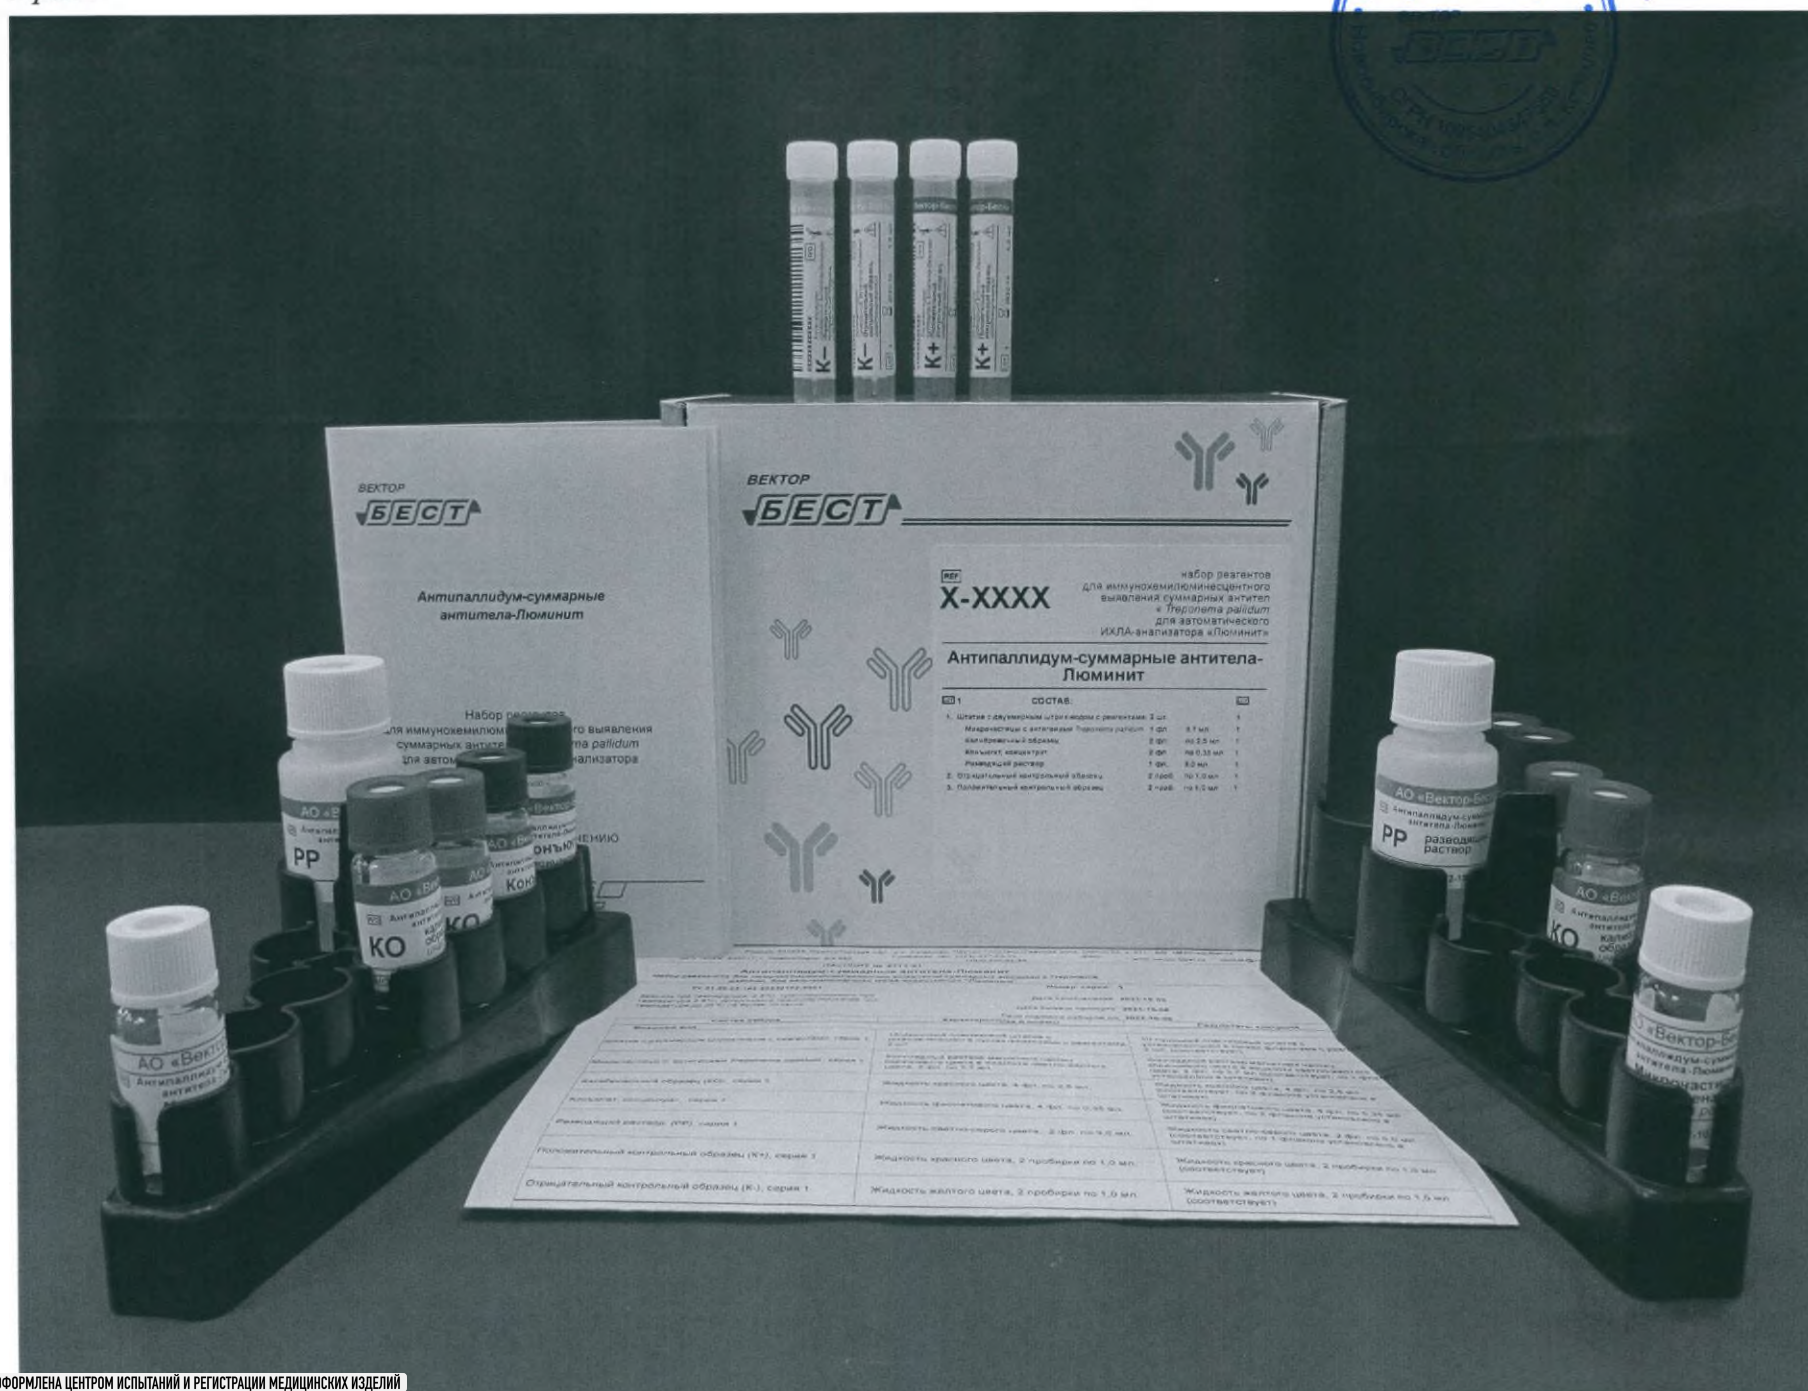

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“Антипаллидум-суммарные антитела-Люминит” № 1
серия 1

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
06 октября 2021 г.




Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
 «Антипаллидум-суммарные антитела-Люминит» № 2
 серия 1



Генеральный директор
 АО «Вектор-Бест»
 М.Д. Хусаинов
 2021 г.


Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“Антипаллидум-суммарные антитела-Люминит” № 3
серия 1

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
06 октябрь 2021 г.

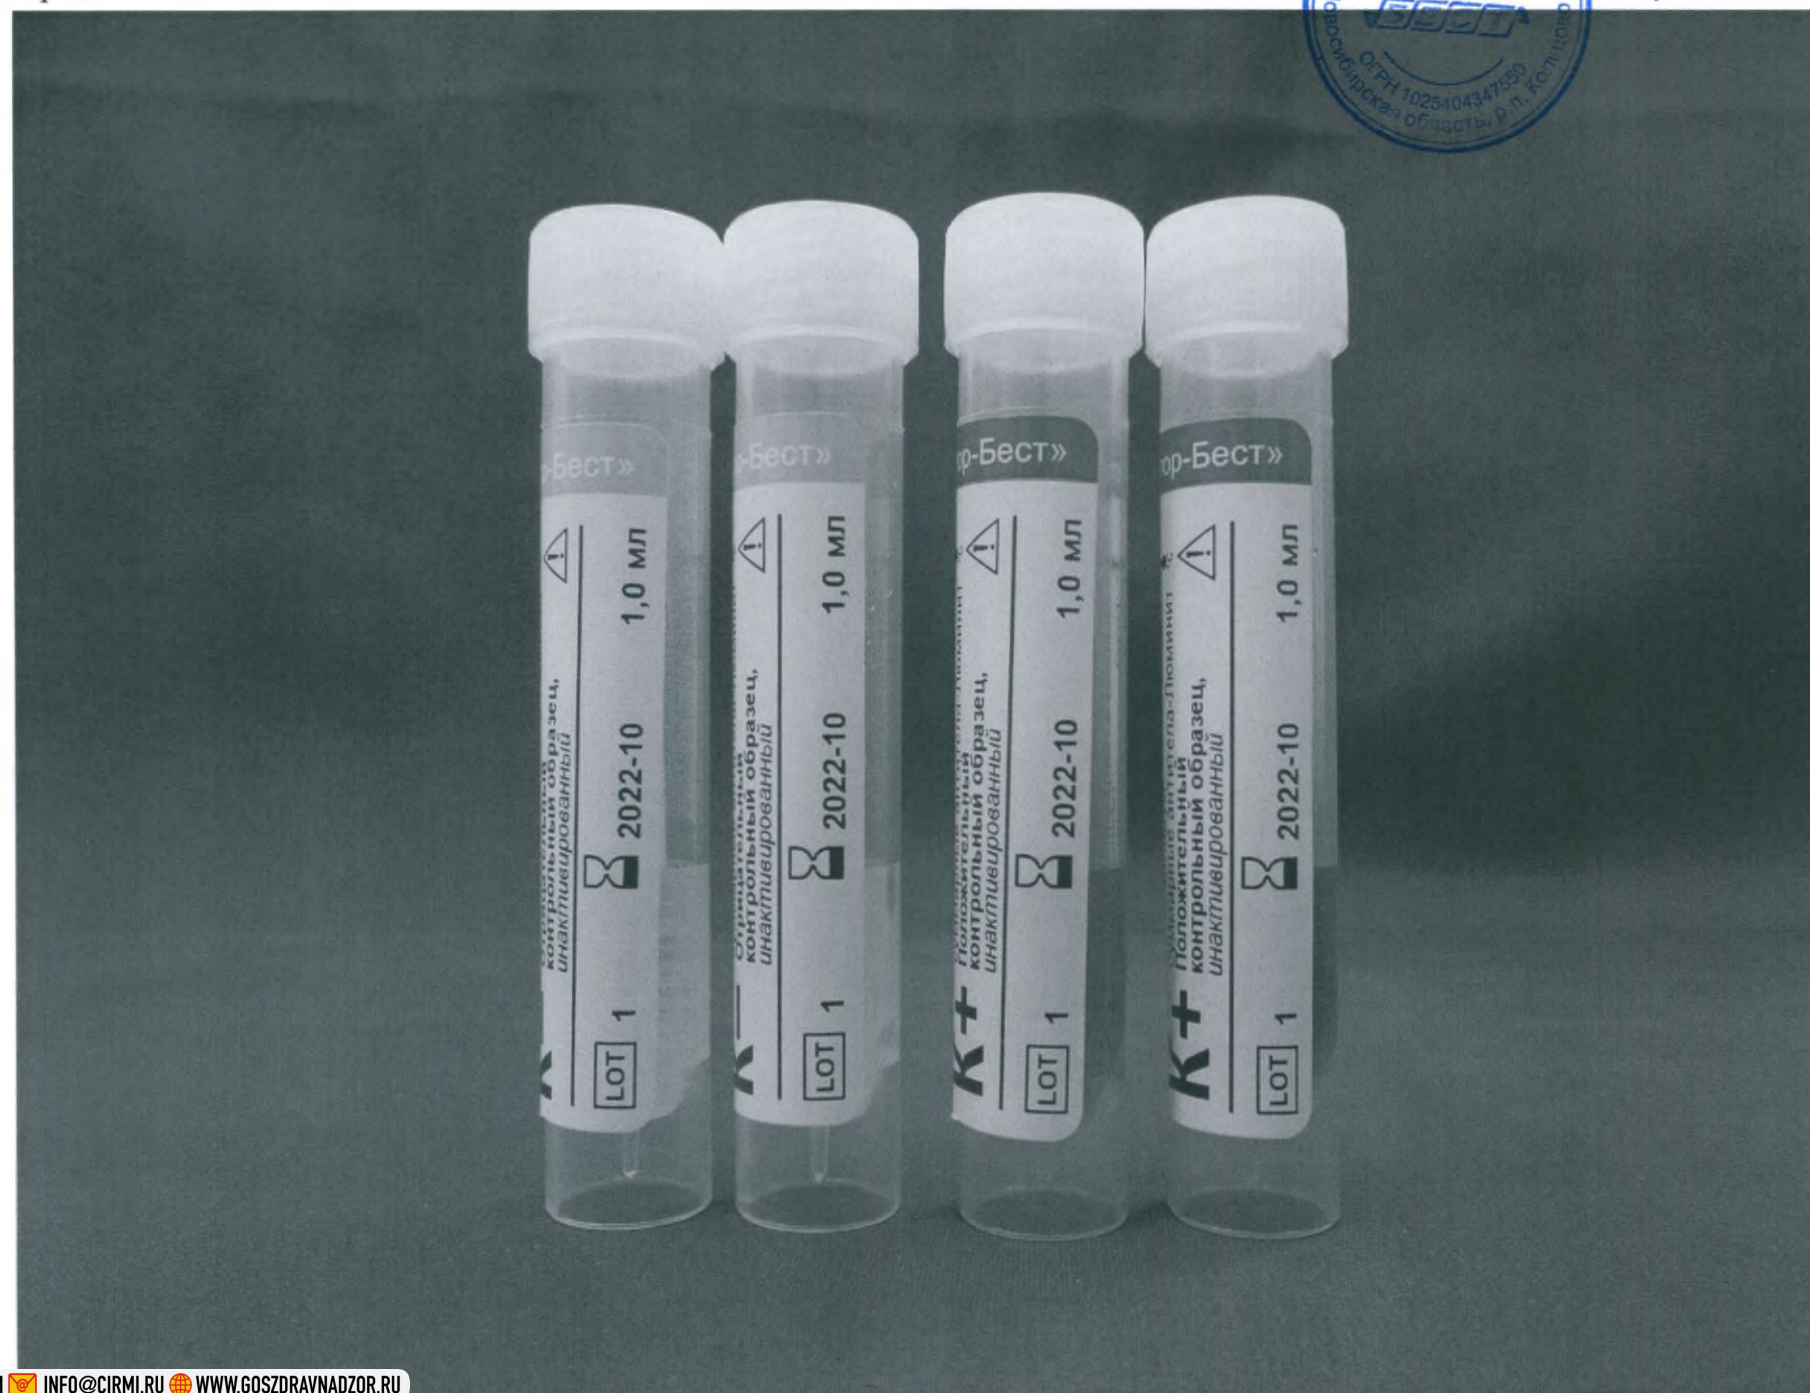


Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“Антипаллидум-суммарные антитела-Люминит” № 4
серия 1

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
“08” октября 2021 г.

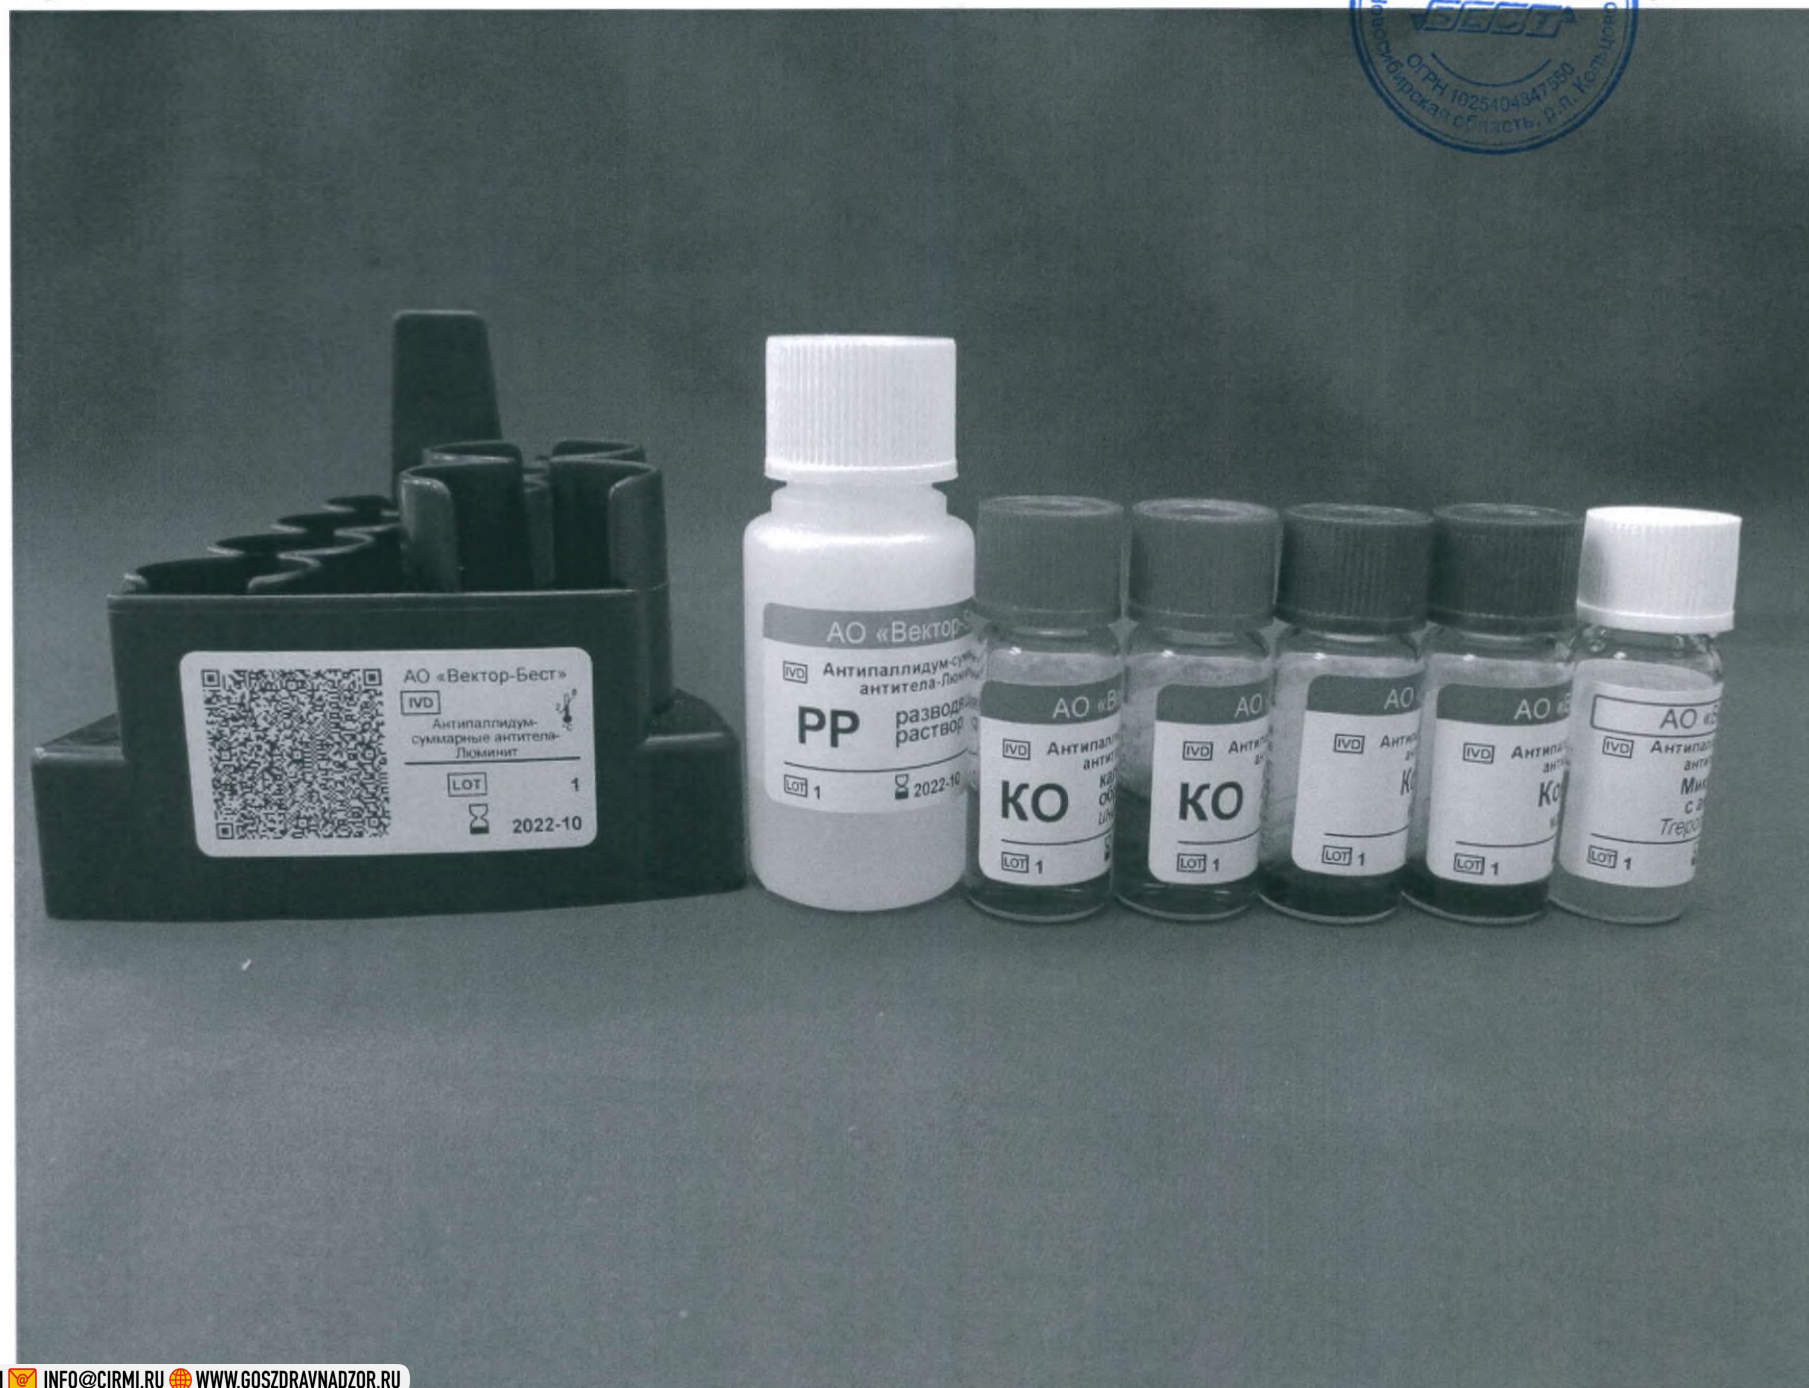


Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“Антипаллидум-суммарные антитела-Люминит” № 5
серия 1

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
“06” октября 2021 г.

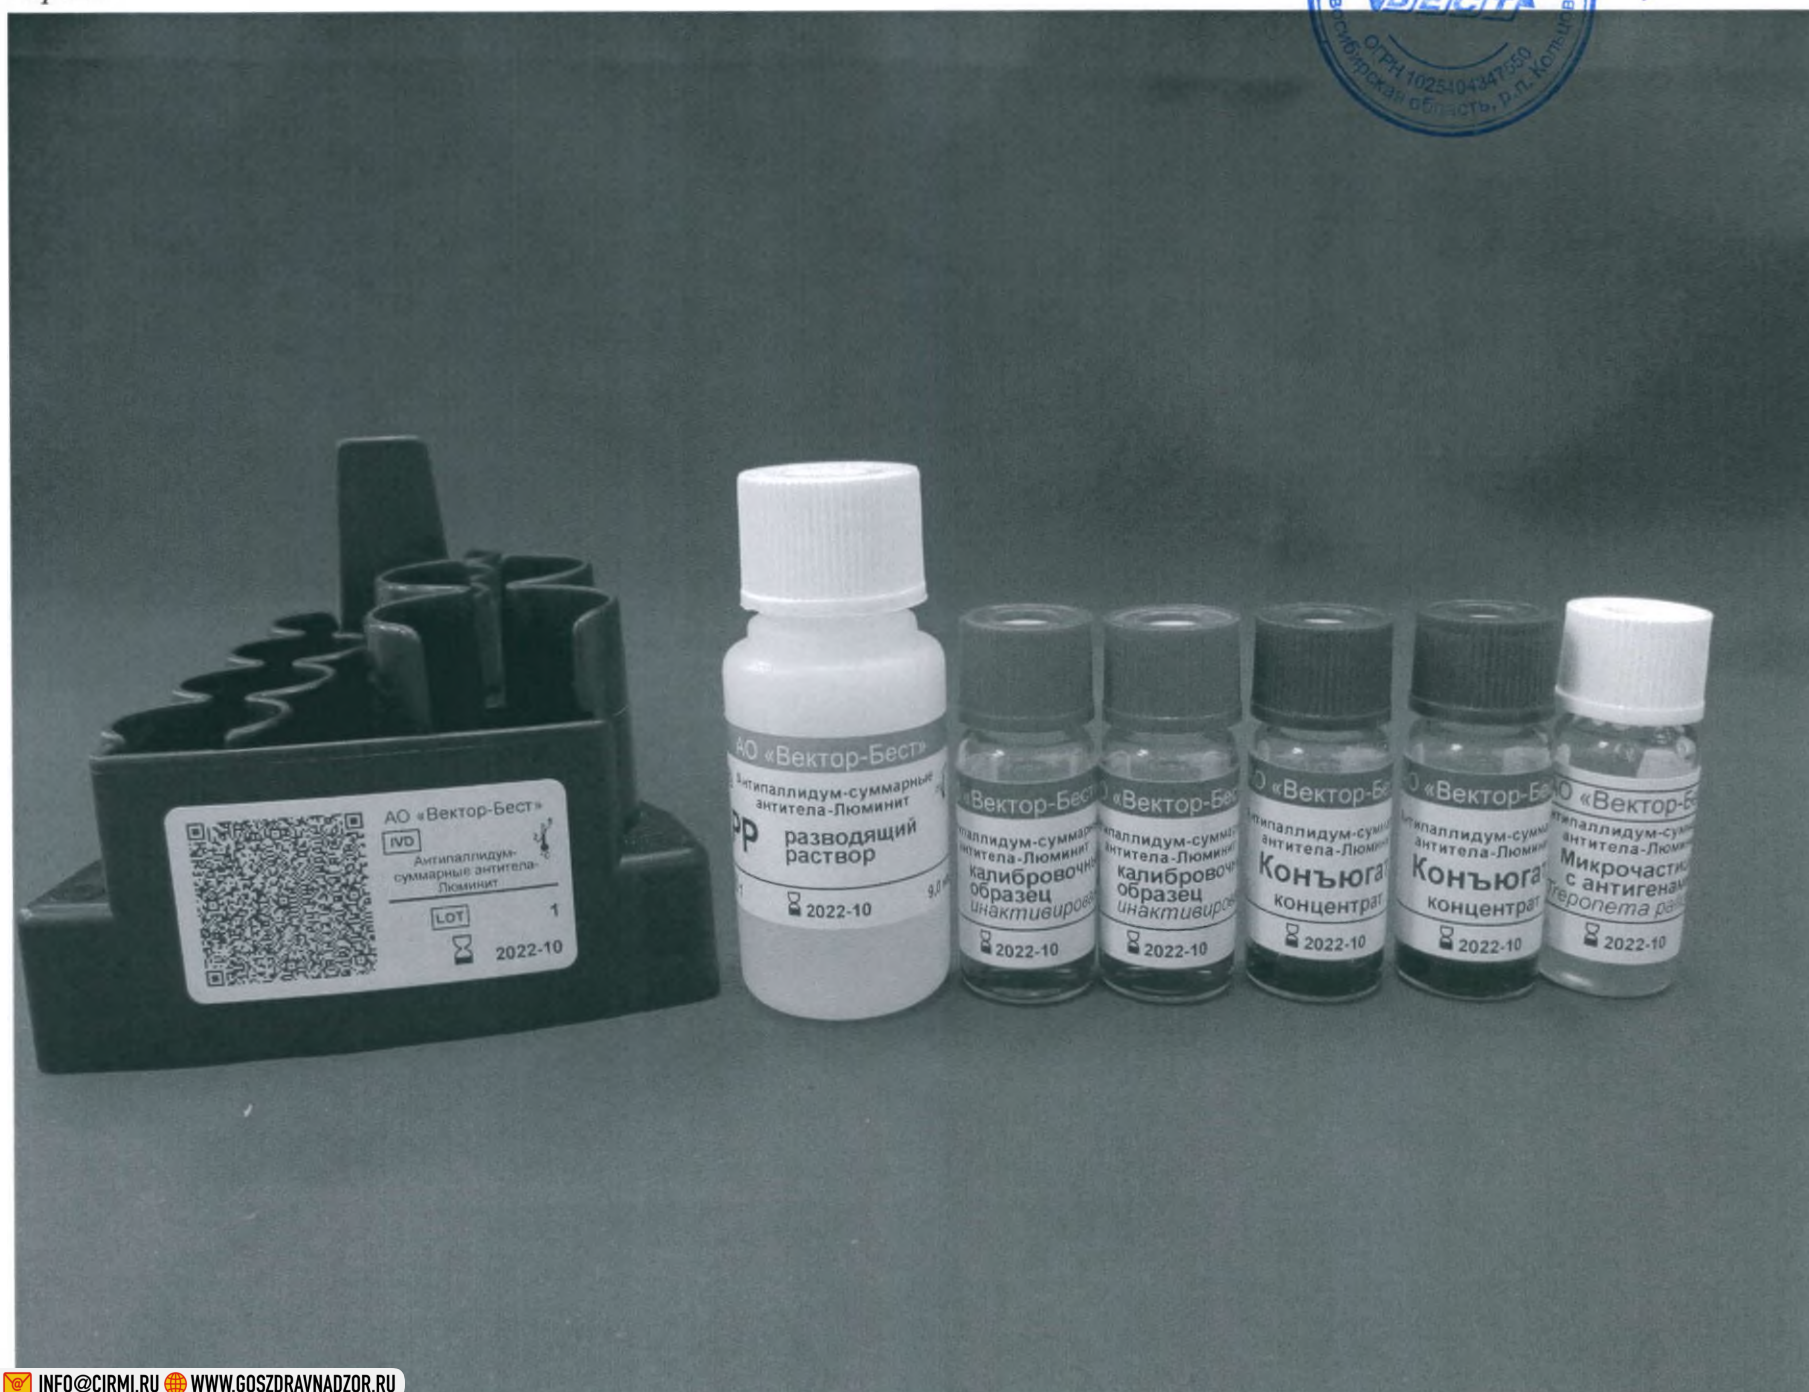

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
"Антипаллидум-суммарные антитела-Люминит" № 6
серия 1

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусаинов
"06 октября 2021 г."

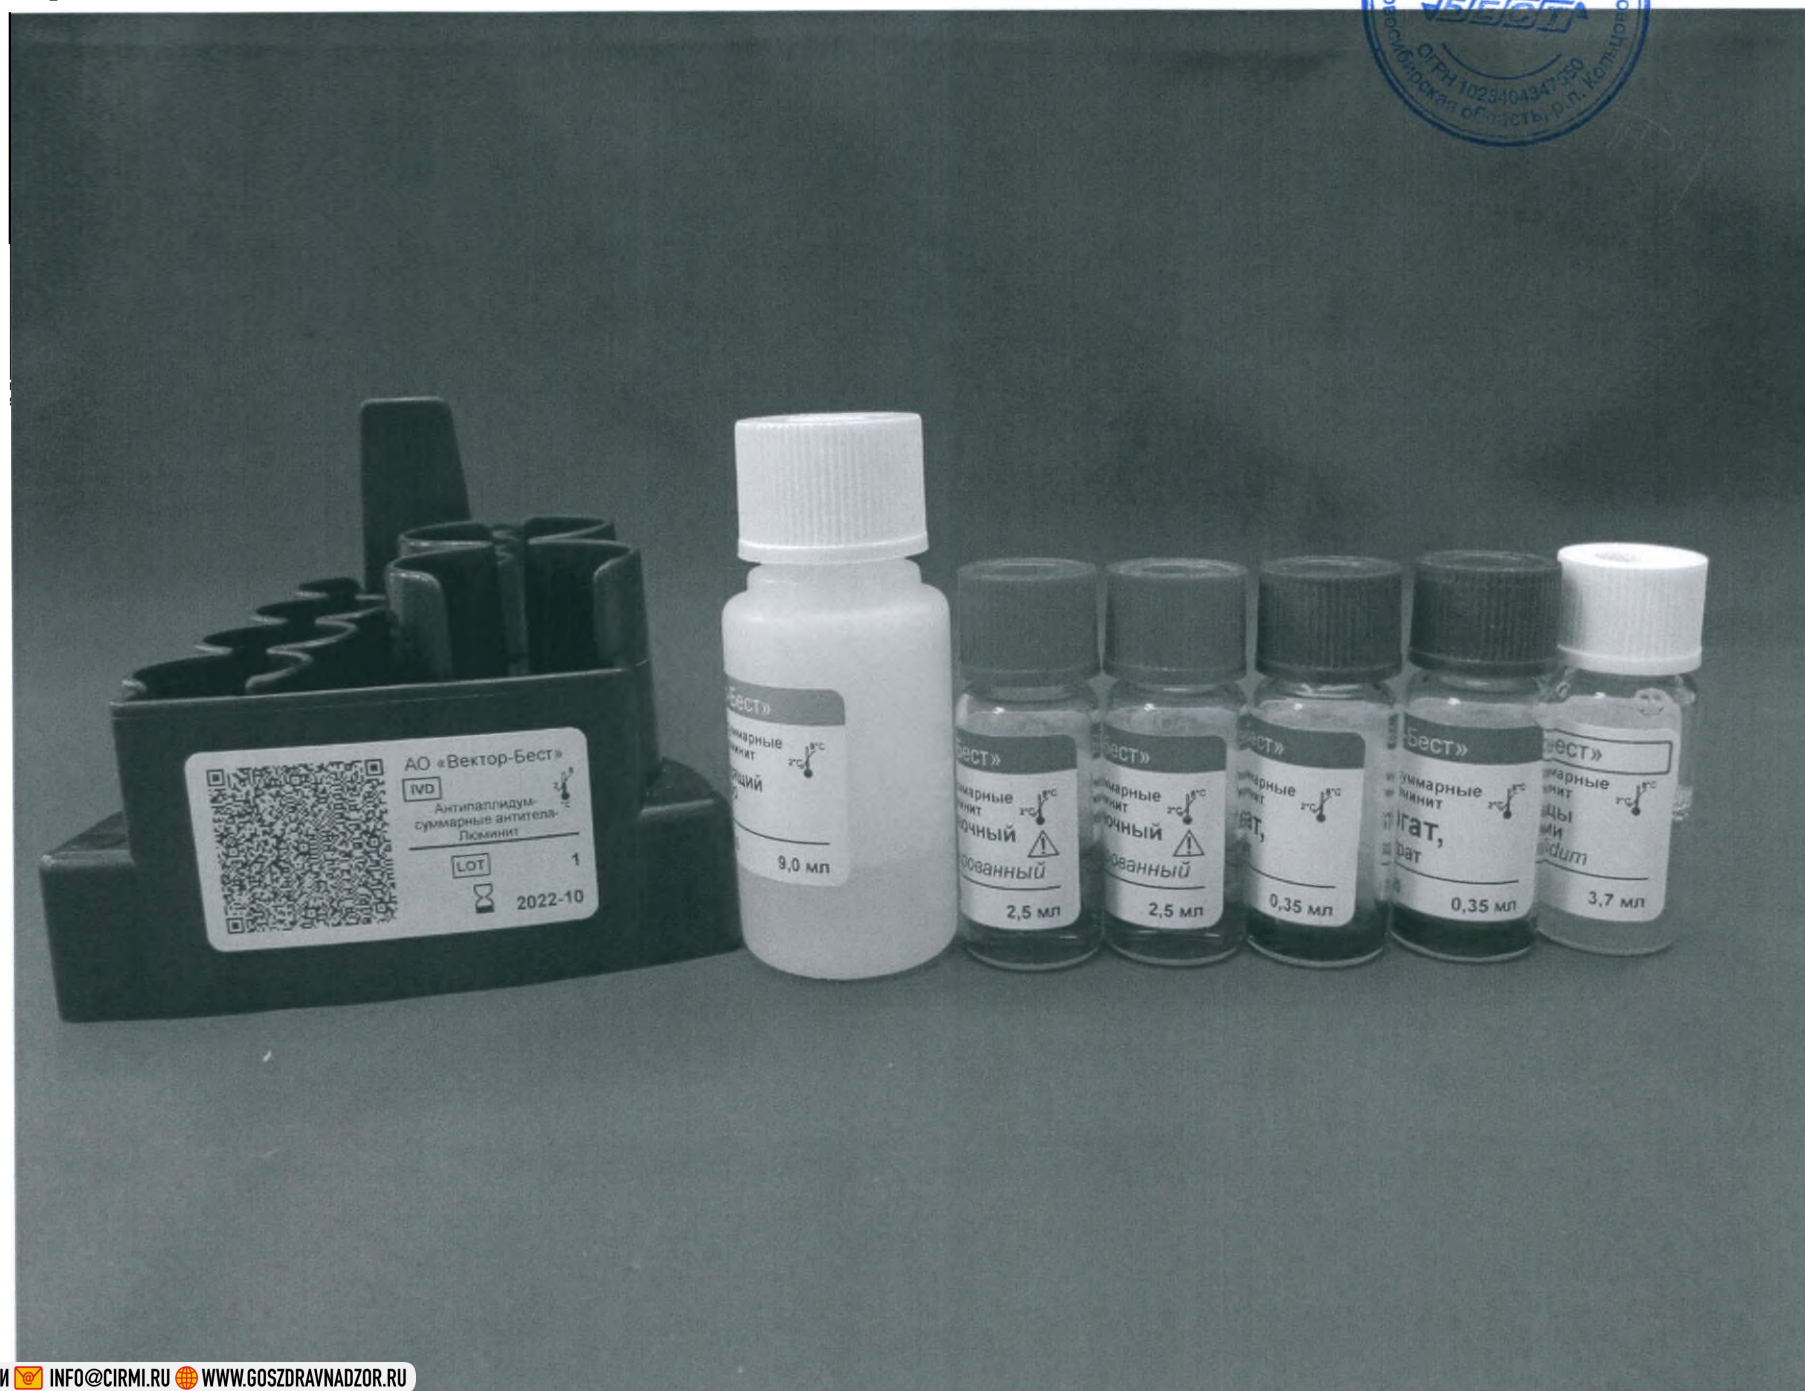


Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
“Антипаллидум-суммарные антитела-Люминит” № 1
серия 1

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
2021 г.




Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
“Антипаллидум-суммарные антитела-Люминит” № 2
серия 1

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
2021 г.

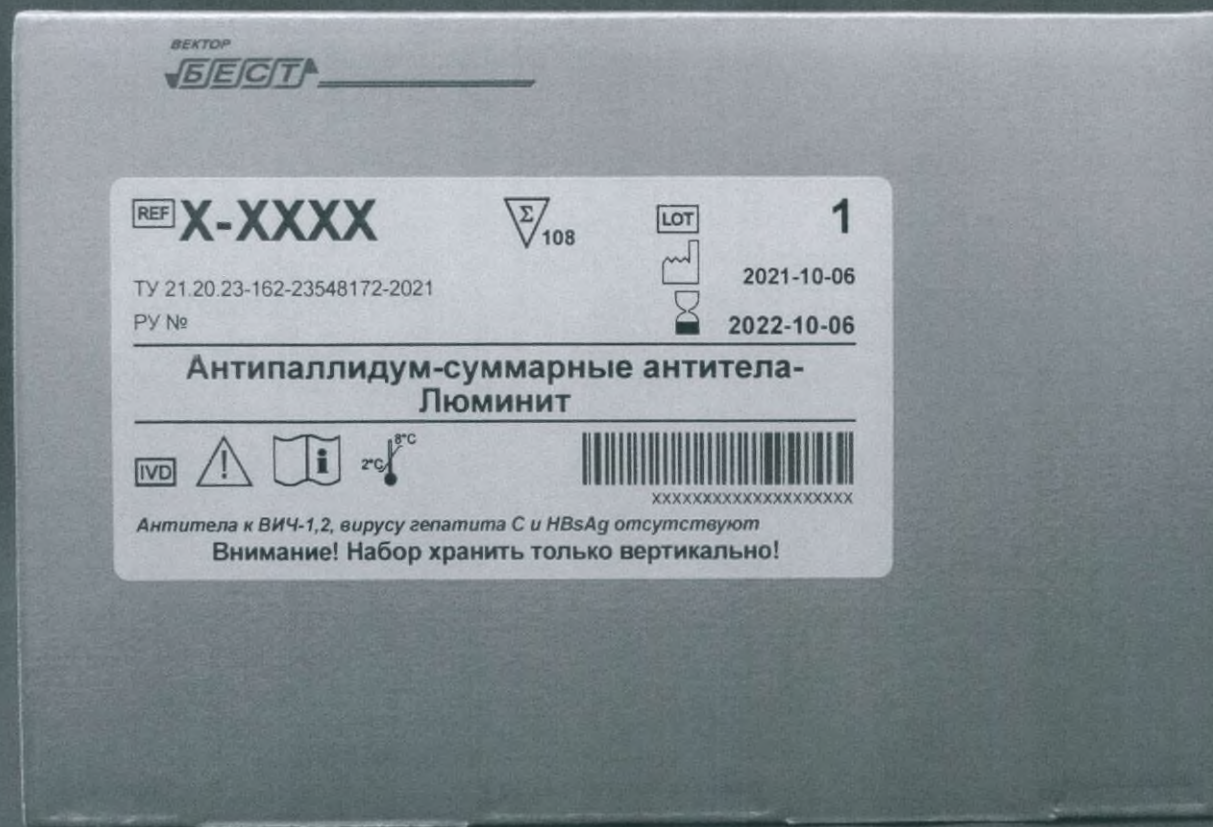


Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
“Антипаллидум-суммарные антитела-Люминит” № 3
серия 1

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
2021 г.

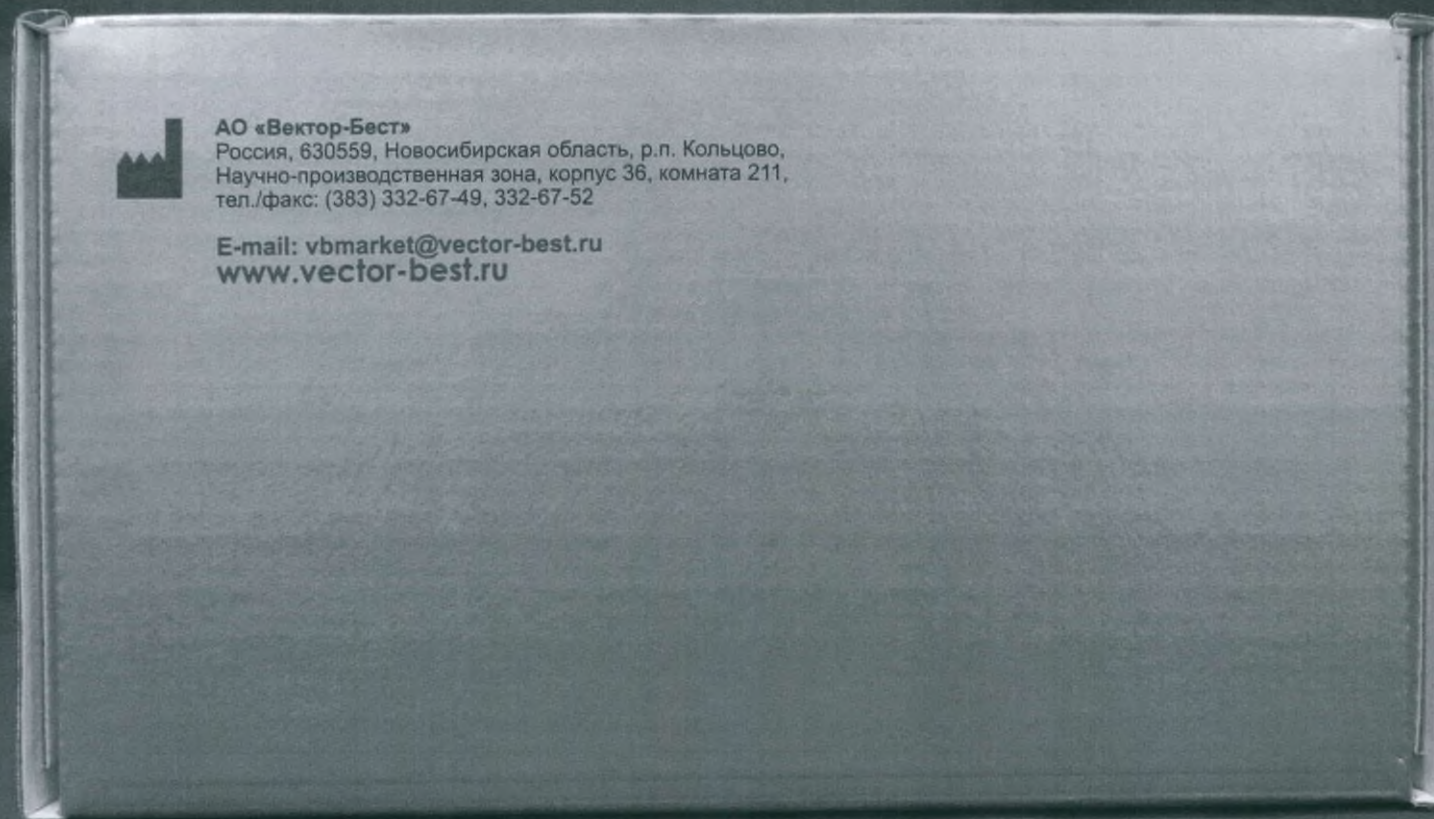

Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
 “Антипаллидум-суммарные антитела-Люминит”
 серия 2

Генеральный директор
 АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
 26 октября 2021 г.

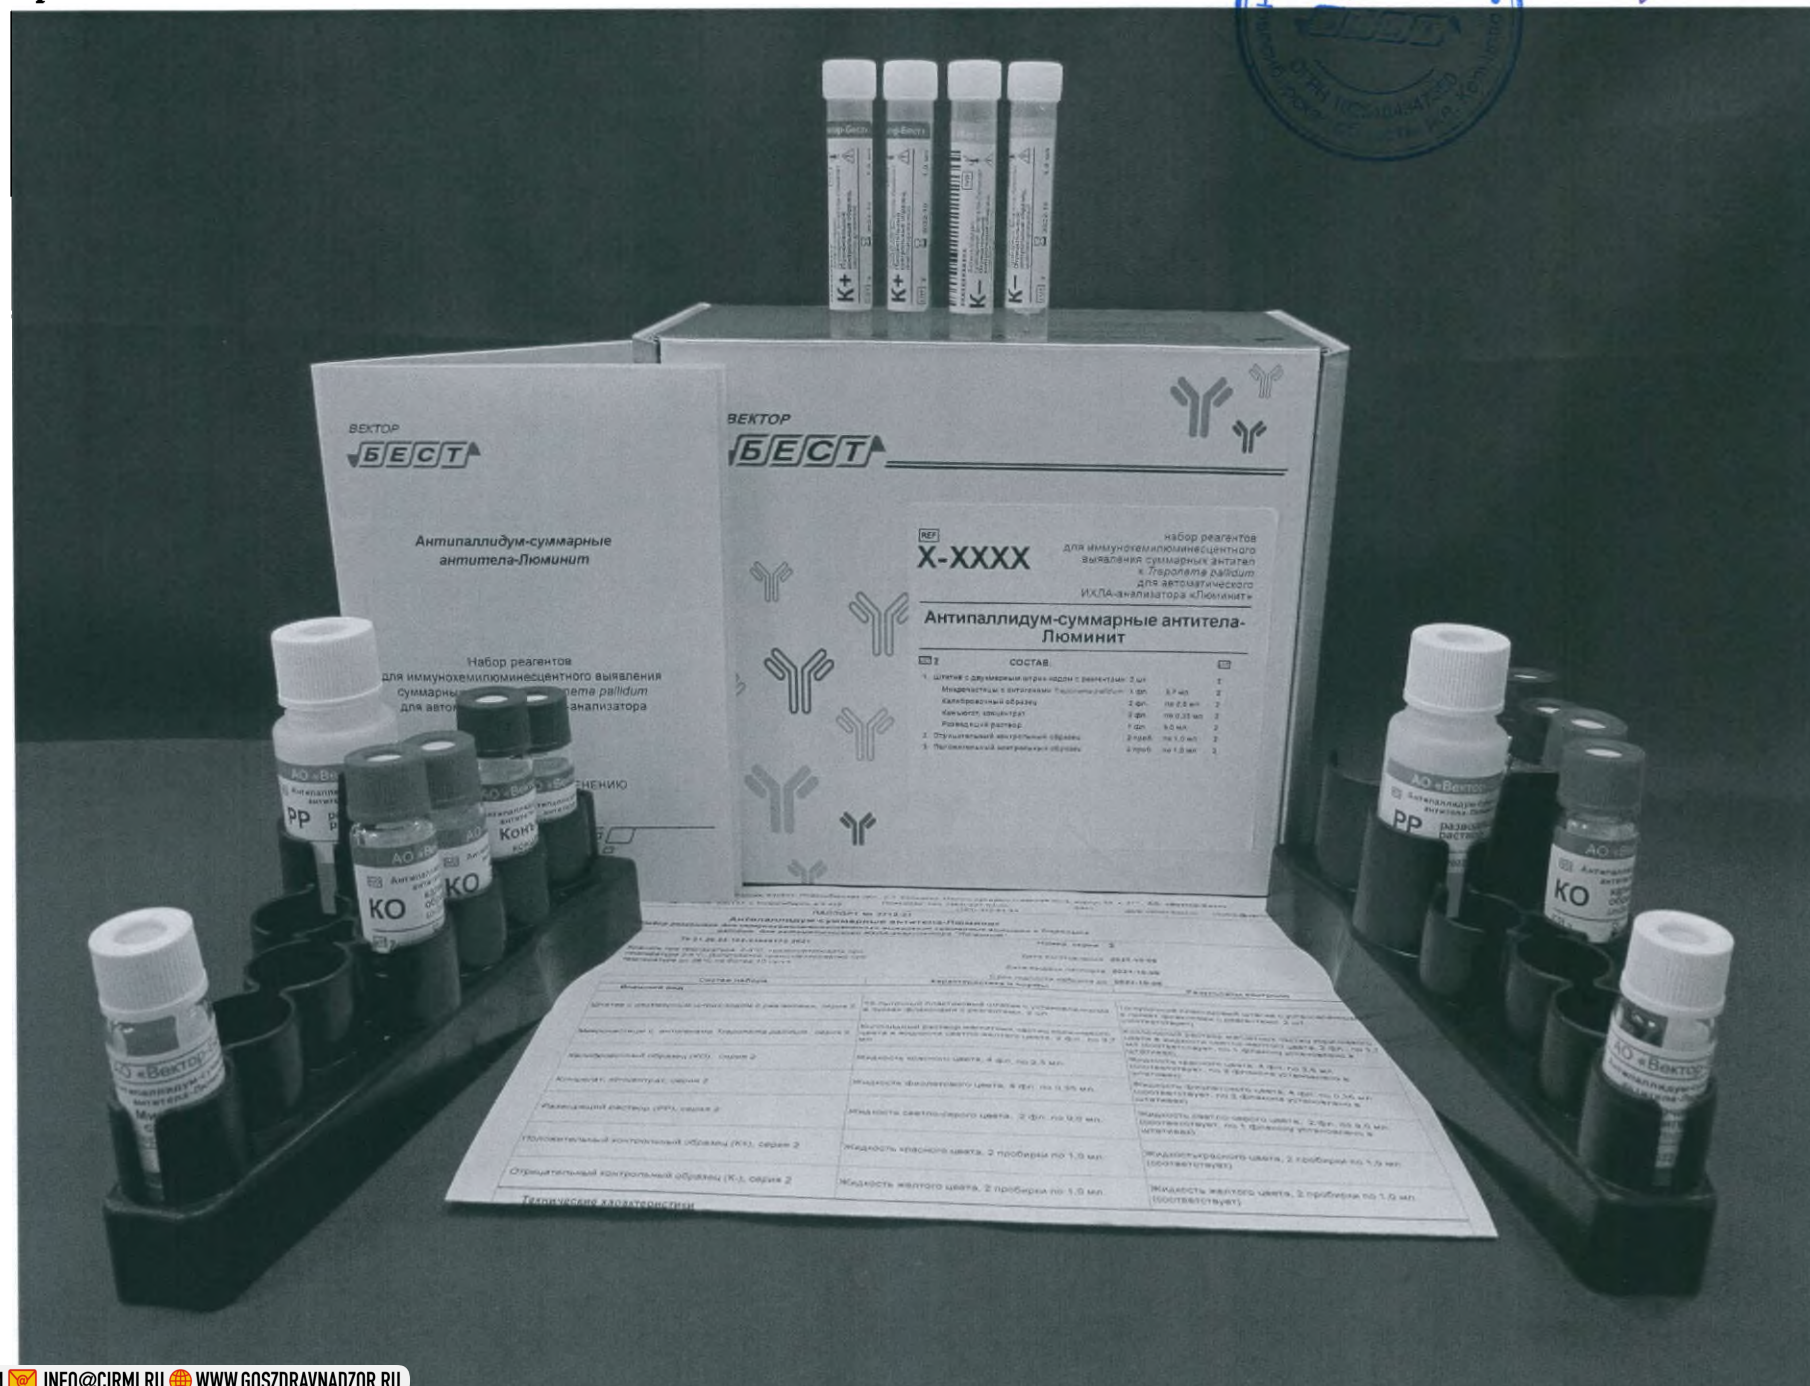

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“Антипаллидум-суммарные антитела-Люминит” № 1
серия 2

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
2021 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
 «Антипаллидум-суммарные антитела-Люминит» № 2
 серия 2



Генеральный директор
 АО «Вектор-Бест»
 М.Д. Хусаинов
 «06» 10 2021 г.

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“Антипаллидум-суммарные антитела-Люминит” № 3
серия 2

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест”


М.Д. Хусаинов

“06” 10 2021 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“Антипаллидум-суммарные антитела-Люминит” № 4
серия 2

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
2021 г.

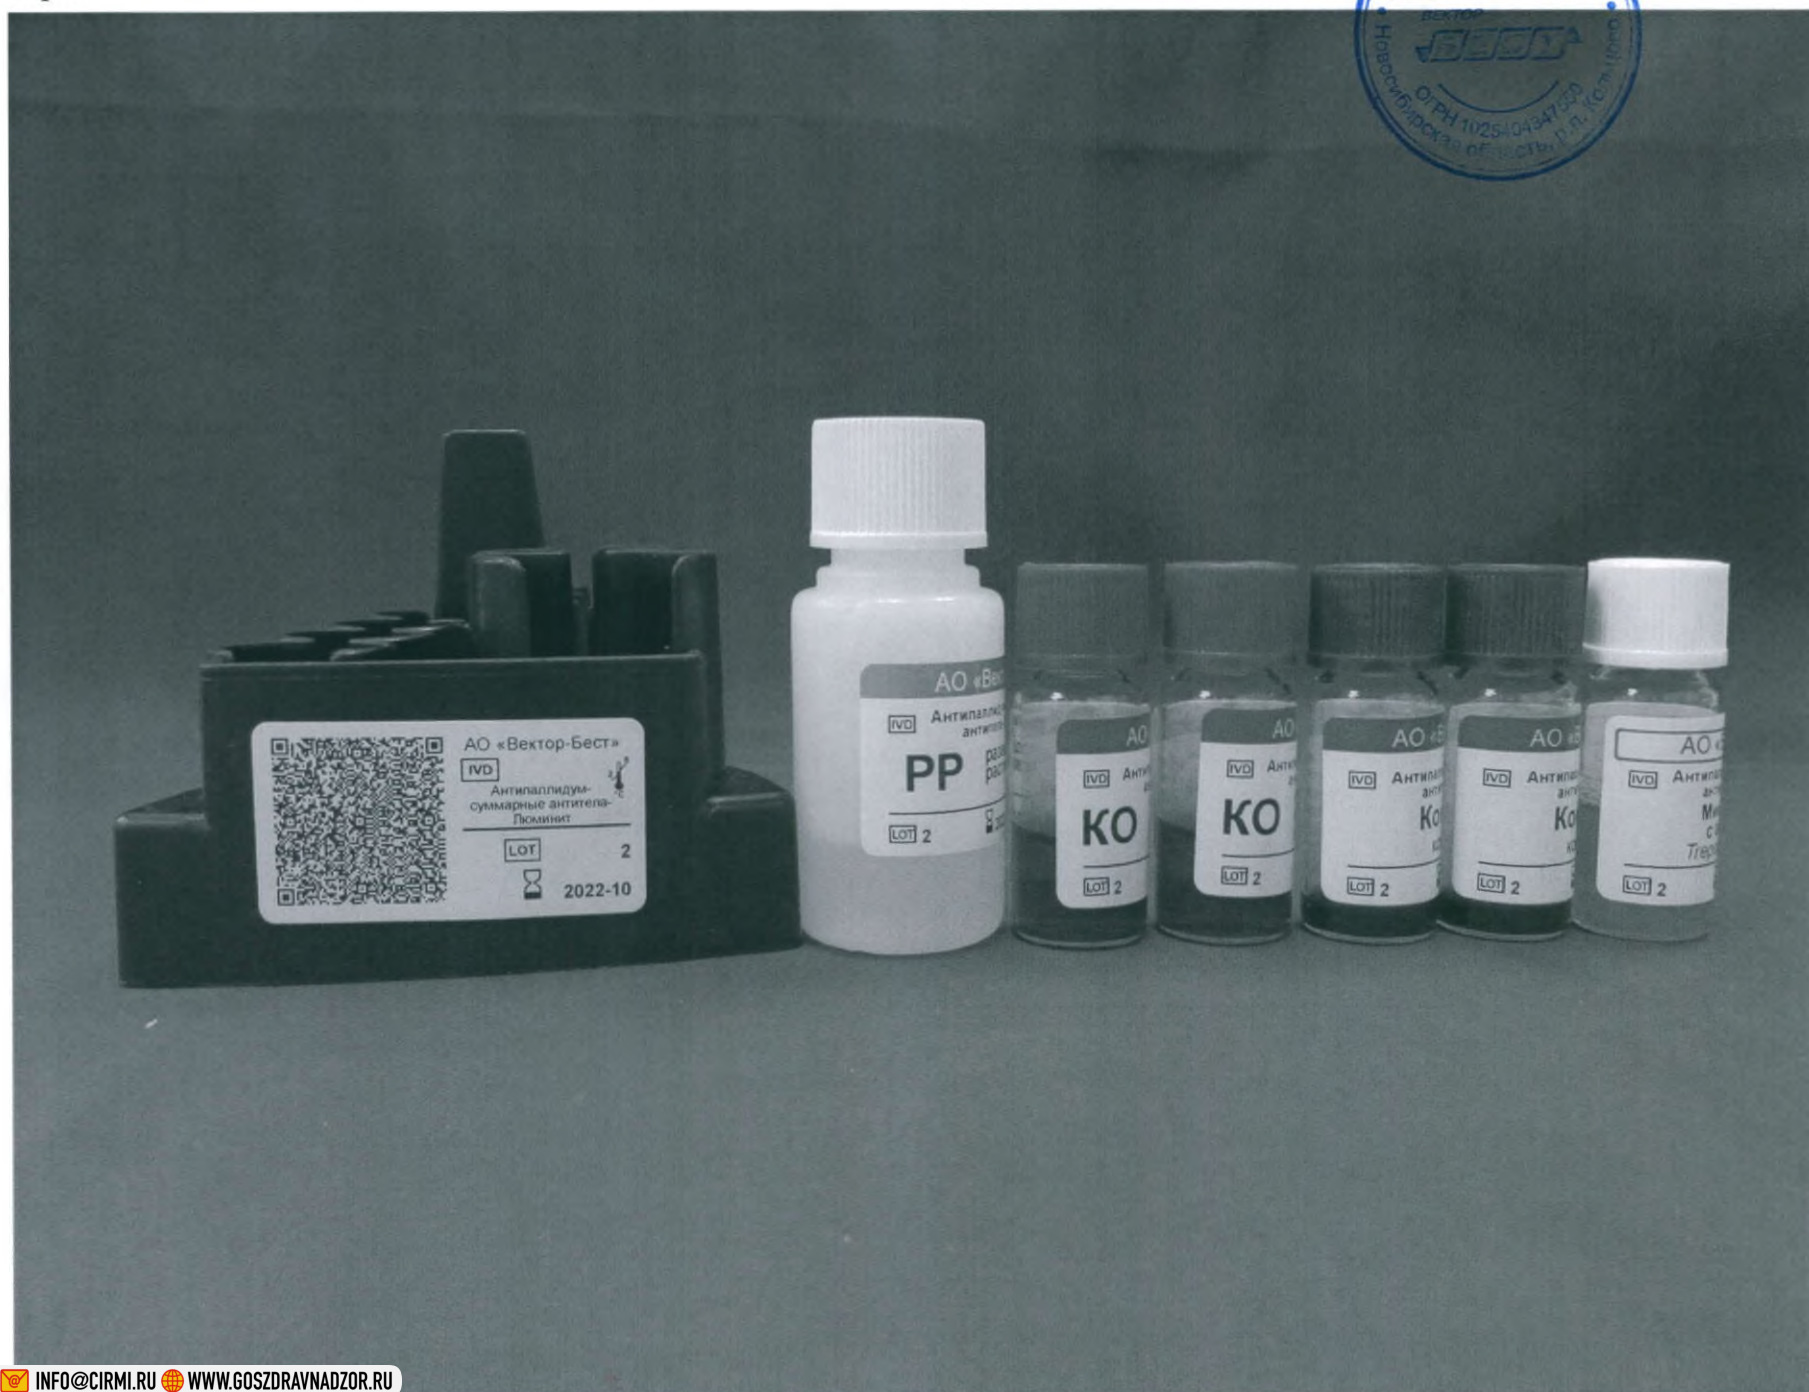

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“Антипаллидум-суммарные антитела-Люминит” № 5
серия 2

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
2021 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“Антипаллидум-суммарные антитела-Люминит” № 6
серия 2

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
“06” 2021 г.



AO «Вектор-Бест»
IVD
Антипаллидум-
суммарные антитела-
Люминит
LOT 2
2022-10

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
“Антипаллидум-суммарные антитела-Люминит” № 1
серия 2

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
2021 г.



ВЕКТОР
БЕСТ

REF

X-XXXX

набор реагентов
для иммунохемилюминесцентного
выявления суммарных антител
к *Treponema pallidum*
для автоматического
ИХЛА-анализатора «Люминит»

Антипаллидум-суммарные антитела- Люминит

LOT 2


СОСТАВ:

LOT

1. Штатив с двухмерным штрих-кодом с реагентами: 2 шт.			2
Микрочастицы с антигенами <i>Treponema pallidum</i>	1 фл.	3,7 мл	2
Калибровочный образец	2 фл.	по 2,5 мл	2
Конъюгат, концентрат	2 фл.	по 0,35 мл	2
Разводящий раствор	1 фл.	9,0 мл	2
2. Отрицательный контрольный образец	2 проб.	по 1,0 мл	2
3. Положительный контрольный образец	2 проб.	по 1,0 мл	2

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
“Антипаллидум-суммарные антитела-Люминит” № 2
серия 2

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
2021 г.

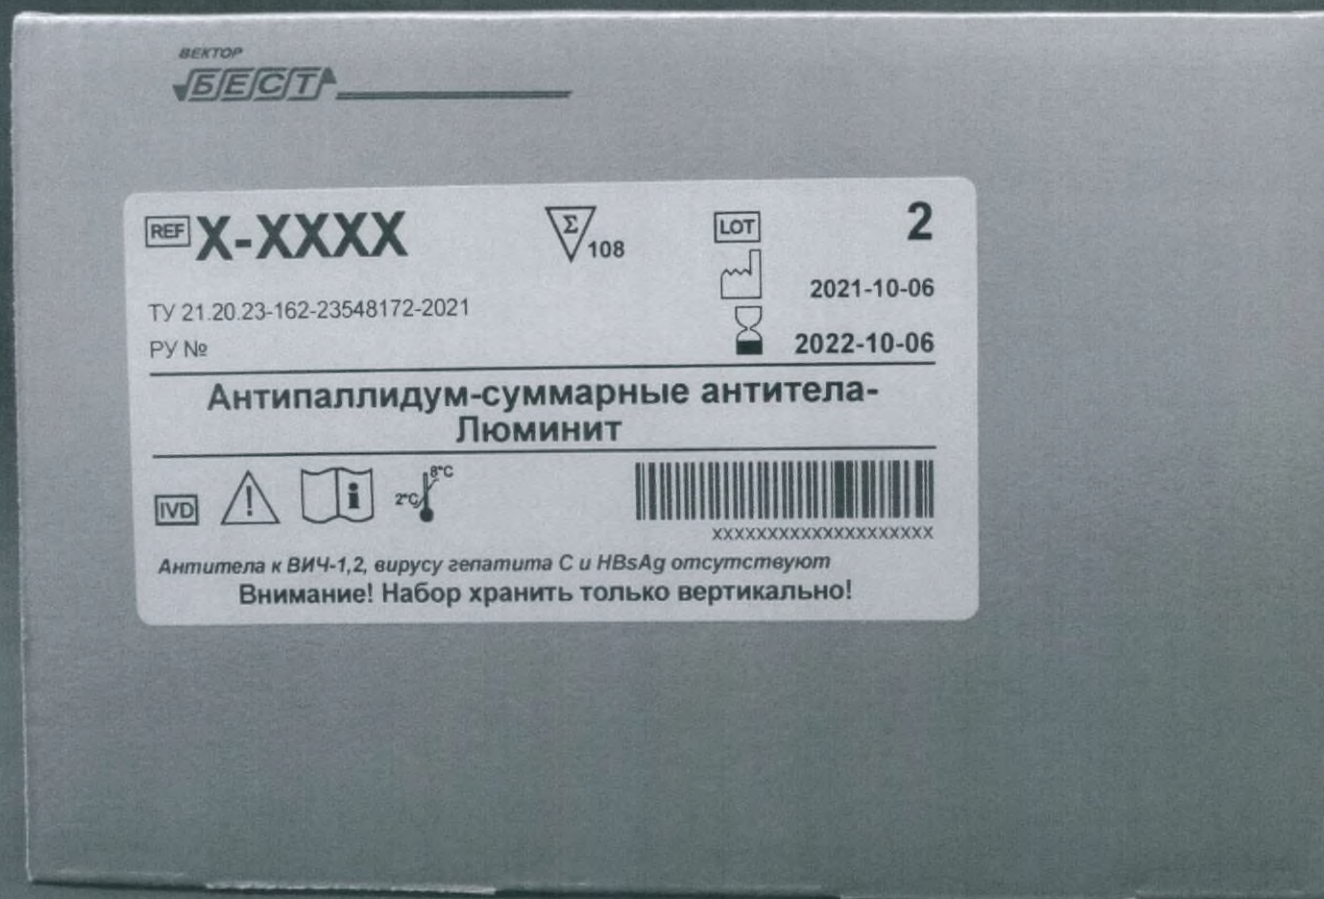

REF **X-XXXX**

Σ 108

LOT

2

ТУ 21.20.23-162-23548172-2021

2021-10-06

РУ №

2022-10-06

**Антипаллидум-суммарные антитела-
Люминит**

IVD




XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Антитела к ВИЧ-1,2, вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

Внимание! Набор хранить только вертикально!

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
“Антипаллидум-суммарные антитела-Люминит” № 3
серия 2

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
“06” 2021 г.

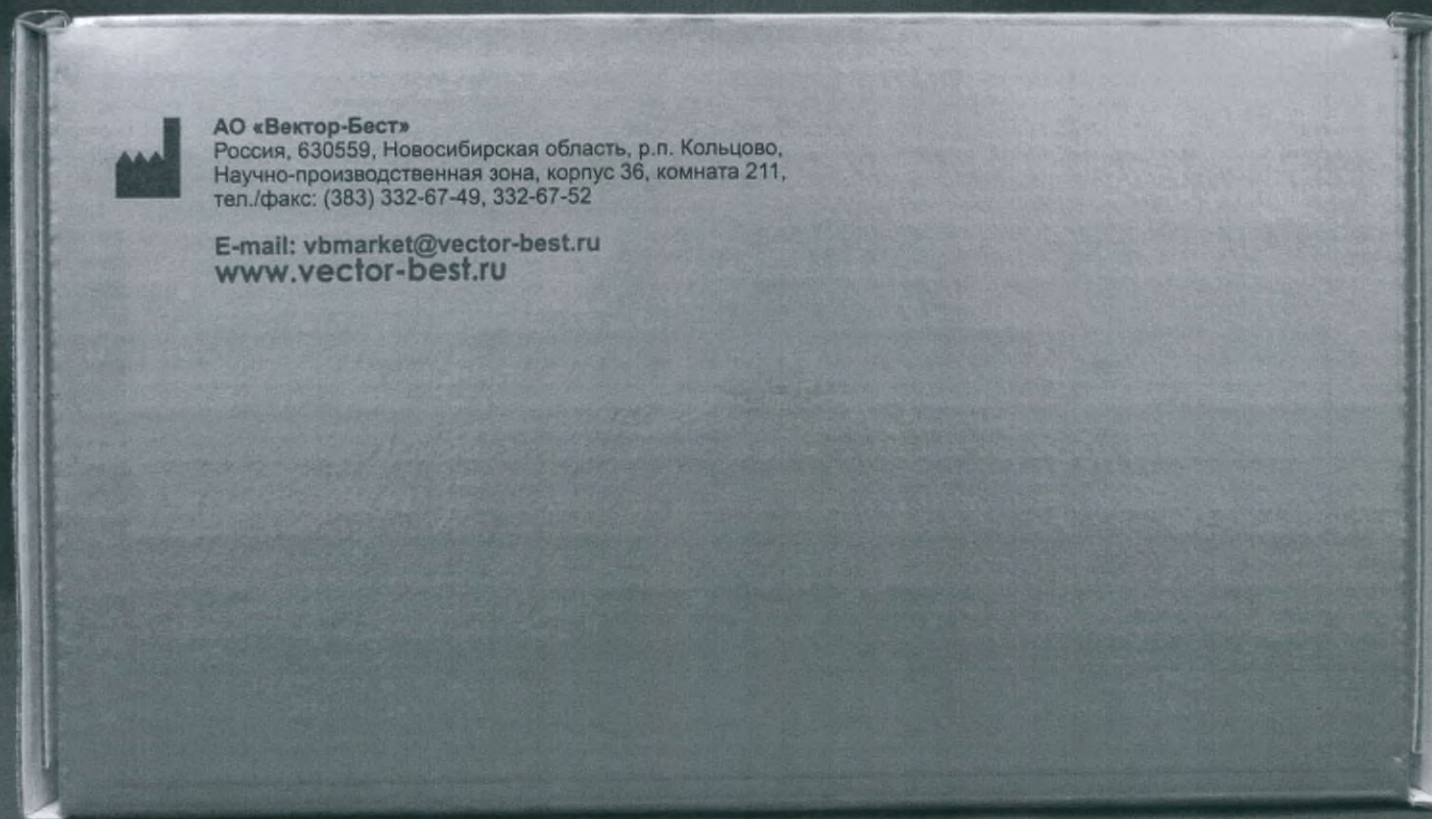



«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»
М.Д. Хусаинов
2021 г.

**Образцы маркировки на Набор реагентов
для иммунохемилюминесцентного выявления суммарных антител к
Treponema pallidum для автоматического ИХЛА-анализатора «Люминит»
«Антипаллидум-суммарные антитела-Люминит»**

1. Образцы этикеток на компоненты набора «Антипаллидум-суммарные антитела-Люминит»

Наименование компонента	Этикетка
Штатив с двухмерным штрих-кодом с реагентами	
Микрочастицы с антигенами <i>Treponema pallidum</i>	
Калибровочный образец (КО)	
Конъюгат, концентрат	
Разводящий раствор (PP)	

Наименование компонента	Этикетка
Положительный контрольный образец (K+)	
Отрицательный контрольный образец (K-)	

2. Образцы этикеток на коробке набора «Антипаллидум-суммарные антитела-Люминит»

2.1. Верхняя этикетка.

REF

набор реагентов для

X-XXXX

иммунохемилюминесцентного выявления

суммарных антител к *Treponema pallidum*

для автоматического ИХЛА-анализатора "Люминит"

Антипаллидум-суммарные антитела-Люминит

LOT XXXX

Состав:

LOT

1. Штатив с двухмерным штрих-кодом с реагентами:

2 шт.

XXXX

Микрочастицы с антигенами *Treponema pallidum*

1 фл., 3,7 мл

XXXX

Калибровочный образец

2 фл. по 2,5 мл

XXXX

Конъюгат, концентрат

2 фл. по 0,35 мл

XXXX

Разводящий раствор

1 фл., 9,0 мл

XXXX

2. Положительный контрольный образец

2 проб. по 1,0 мл

XXXX

3. Отрицательный контрольный образец

2 проб. по 1,0 мл

XXXX

2.2. Боковая этикетка № 1.

REF	X-XXXX	Σ 108	LOT	XXXX
ТУ 21.20.23-162-23548172-2021 РУ №			XXXX-XX-XX	XXXX-XX-XX
Антипаллидум-суммарные антитела-Люминит				
IVD				XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Антитела к ВИЧ-1,2, вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют				
Внимание! Набор хранить только вертикально!				

2.3. Боковая этикетка № 2.

АО «Вектор-Бест» Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, Научно-производственная зона, корпус 36, комната 211 тел/факс: (383) 252-51-64, 252-51-67 E-mail: vbmarket@vector-best.ru www.vector-best.ru
--

Примечание. Текст боковой этикетки № 2 может быть нанесен непосредственно на коробку типографским способом.

«СОГЛАСОВАНО»
Директор НИИСД
АО «Вектор-Бест»

М.Ю. Рукавишников
«01» октября 2021 г.

«СОГЛАСОВАНО»
Директор по производству
АО «Вектор-Бест»

В.К. Ткачев
«01» октября 2021 г.

Прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью 3 лист(ов).
Директор по технологии и качеству /
АО "Вектор-Бест"



А.В. Масяго
"01" октября 2021 г.