

Фотографии медицинского изделия для диагностики *in vitro*

**Набор реагентов для выявления ДНК *Ureaplasma urealyticum* и
Ureaplasma parvum методом ПЦР с флуоресцентной детекцией
в режиме реального времени «Интифика *Ureaplasma urealyticum* /
Ureaplasma parvum», по ТУ 21.20.23-257-98539446-2021,
производства ООО «Компания Алкор Био»**

Вариант исполнения 1

стр. 2

Вариант исполнения 2

стр. 3

Генеральный директор
ООО «Компания Алкор Био»



Полынцев Д.Г.

Набор реагентов для амплификации ДНК Флюоридикс и Флюоридикс ривит методом ПЦР с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени по Т/У 21.20.23-257.085.36446-2001.

444-01 2023-06-23

IVD   


TY 21 20 23 257-98539-445-2010
R5

Fy

Состав набора:

1. ПЦР-смесь-Uu/Ur	14 стрелов по 8 микропр.
2. Таq	1 пр.
3. ПКО	1 пр.
4. ВКО	2 пр.
5. ОКД	1 пр.

ПЦР-смесь-Uni/Up
Инфекция
Ureaplasma urealyticum /
Ureaplasma parvum
форма 5
14 стрелок   IVD
на 8 микролитров (на 10 мкл)
серия 018
годен до 2022-03-23
кранити при +2...+8 °C
после к микробиологич.
СОС "Киевские Альянс Био"




PREFACE TO THE SECOND EDITION

Микроинформатика является для диагностики и в целом
Набор реактивов для выявления ДНК *Escherichia coli* и *Escherichia parvum*
методом ПЦР с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени
а) *Escherichia coli* и *Escherichia parvum*
по 85 28 26 25 247 308519446 3671

Microfilaria <i>Onchocerca volvulus</i> / <i>Onchocerca pumilus</i>	Фигура 5	стр. № 444-47
--	----------	---------------

Патентная Заявка на изобретение / Изобретение раскрыто	Формы Т	к.п. № 644-02
---	---------	---------------



Набор реагентов для выделения ДНК *Ureaplasma urealyticum* и *Ureaplasma parvum* методом ПЦР с флуоресцентной детекцией и режиме реального времени «Интификс *Ureaplasma urealyticum* / *Ureaplasma parvum*», по ТУ 21.20.23-257-98539446-2021

Кат № 444.01	Формат 3	
Сериал № 090885	Формат издания № 1	Кол-во листов 52 шт.

[illegible]

ООО «Компания Альянс»
г. Санкт-Петербург, Коллонтаевский пр., дом 63, лит. А
Телефон/факс: (812) 673-63-79

В К Л А Д Ы Ш № ОР0185




Набор реактивов для амплификации ДНК *Cryptosporidium parvum* в *Cryptosporidium parvum* методом ПЦП с флуоресцентной меткой и режимом реального времени «Интатип» *Cryptosporidium parvum*/ *Cryptosporidium parvum*, по ТУ 11.20.23-257-98539446-2021

Kerr No. 444-D)

Среды No QP11-15	Формула %	Фосфоризация No 1	Калийность 20 кат.	
Инициализация адаптации к среде по параметру	Полученные данные			
	CFM6	ДТ по пробам милл	Light Cycle %	Quantal Yield 5
Параметры инициации для Cu/Br (насос EOX)	26	23	25	25
Параметры инициации для Cu/Br (насос HEOX)	24	23	22	23
Параметры инициации для Cu/Br (насос FOM)	26	23	25	23
Параметры инициации Cu/Br (насос EOX)	41	43	45	45
Параметры инициации Cu/Br (насос HEOX)	45	43	42	43



Оберина М.Н.

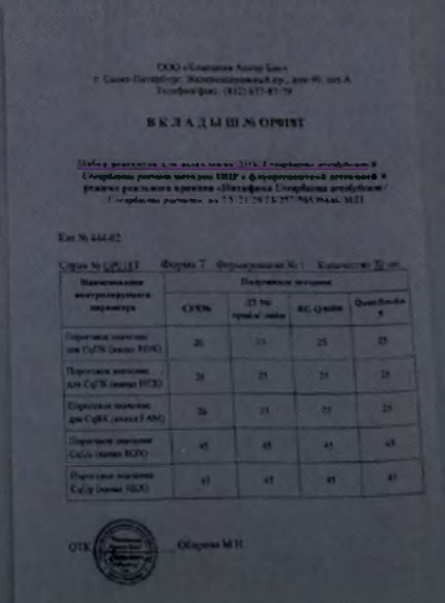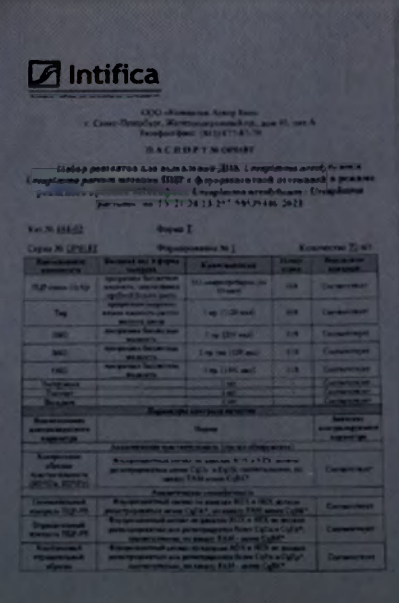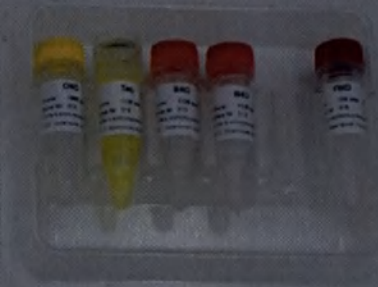

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью

3 (774) листа

Генеральный директор

ООО «Компания Алкор Био»

Д.А. Полинцев



Макет этикеток на медицинское изделие для диагностики *in vitro*

**Набор реагентов для выявления ДНК *Ureaplasma urealyticum* и
Ureaplasma parvum методом ПЦР с флуоресцентной детекцией
в режиме реального времени «Интифика *Ureaplasma urealyticum* /
Ureaplasma parvum», по ТУ 21.20.23-257-98539446-2021,
производства ООО «Компания Алкор Био»**

**Генеральный директор
ООО «Компания Алкор Био»**



Полынцев Д.Г.

Набор реагентов для выявления ДНК *Ureaplasma urealyticum* и *Ureaplasma parvum* методом ПЦР с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени «Интифика *Ureaplasma urealyticum* / *Ureaplasma parvum*», по ТУ 21.20.23-257-98539446-2021

Макет этикеток



Вариант исполнения Форма S

Кат. № 444-01

На коробку:

Intifica

Интифика

**Ureaplasma urealyticum /
Ureaplasma parvum**

LOT OP030T

2023-06-23

+2...+8 °C

**Интифика *Ureaplasma urealyticum* /
*Ureaplasma parvum***

Набор реагентов для выявления ДНК *Ureaplasma urealyticum* и *Ureaplasma parvum* методом ПЦР с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени по ТУ 21.20.23-257-98539446-2021»

Форма S

Состав набора:

1. ПЦР-смесь-Uu/Up	14 стрипов по 8 микропр.
2. Taq	1 пр.
3. ПКО	1 пр.
4. ВКО	2 пр.
5. ОКО	1 пр.

ТУ 21.20.23-257-98539446-2016
РУ

Интифика

**Ureaplasma urealyticum /
Ureaplasma parvum**

2 0 0 0 0 2 7 7 3 0 7 7 3 V003

Intifica

На флаконы:

Intifica

ПЦР-смесь-Uu/Up

Интифика

***Ureaplasma urealyticum* /
*Ureaplasma parvum***

Форма S

14 стрипов

по 8 микропробирок (по 10 мкл)

серия № 018

годен до 2022-03-23

хранить при +2...+8 °C

готов к использованию

ООО "Компания Алкор Био"

Intifica

Taq

объем 1120 мкл

серия № 018

готов к использованию

ООО "Компания Алкор Био"

Intifica

ВКО

объем 1120 мкл

серия № 018

готов к использованию

ООО "Компания Алкор Био"

Intifica

ПКО

объем 250 мкл

серия № 018

готов к использованию

ООО "Компания Алкор Био"

Intifica

ОКО

объем 1500 мкл

серия № 018

готов к использованию

ООО "Компания Алкор Био"

Набор реагентов для выявления ДНК *Ureaplasma urealyticum* и *Ureaplasma parvum* методом ПЦР с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени «Интифика *Ureaplasma urealyticum* / *Ureaplasma parvum*»,
по ТУ 21.20.23-257-98539446-2021

Макет этикеток



Вариант исполнения Форма Т

Кат. № 444-02

На коробку:

Intifica

Интифика
Ureaplasma urealyticum /
Ureaplasma parvum

LOT OP030T

2023-06-23

+2...+8 °C

**Интифика *Ureaplasma urealyticum* /
*Ureaplasma parvum***

Набор реагентов для выявления ДНК *Ureaplasma urealyticum* и *Ureaplasma parvum* методом ПЦР с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени по ТУ 21.20.23-257-98539446-2021»

LOT	OP030T		2022-06-23
REF	444-02		2023-06-23
IVD			+2...+8 °C
	112		

ТУ 21.20.23-257-98539446-2016
ру

Форма Т

Состав набора:

1. ПЦР-смесь-Uu/Up	112 микропр.
2. Taq	1 пр.
3. ПКО	1 пр.
4. ВКО	2 пр.
5. ОКО	1 пр.

Интифика
Ureaplasma urealyticum /
Ureaplasma parvum

2 0 0 0 0 2 7 7 3 0 7 7 3 V003

Intifica F1

На флаконы:

Intifica

ПЦР-смесь-Uu/Up
Интифика
Ureaplasma urealyticum /
Ureaplasma parvum

Форма Т

112 микропробирок (по 10 мкл)
серия № 018
годен до 2022-03-23
хранить при +2...+8 °C
готов к использованию
ООО "Компания Алкор Био"

Intifica

Taq

объем 1120 мкл
серия № 018
готов к использованию
ООО "Компания Алкор Био"

Intifica

ВКО

объем 1120 мкл
серия № 018
готов к использованию
ООО "Компания Алкор Био"

Intifica

ПКО

объем 250 мкл
серия № 018
готов к использованию
ООО "Компания Алкор Био"

Intifica

ОКО

объем 1500 мкл
серия № 015
готов к использованию
ООО "Компания Алкор Био"

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью

3 (ИМ) лист 9

Генеральный директор

ООО «Компания Алкор Био»

Д.Г. Полинцев

