


Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
 "Анти-ВГС-Люминит"
 серия 1

Генеральный директор
 АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусаинов
 2021 г.

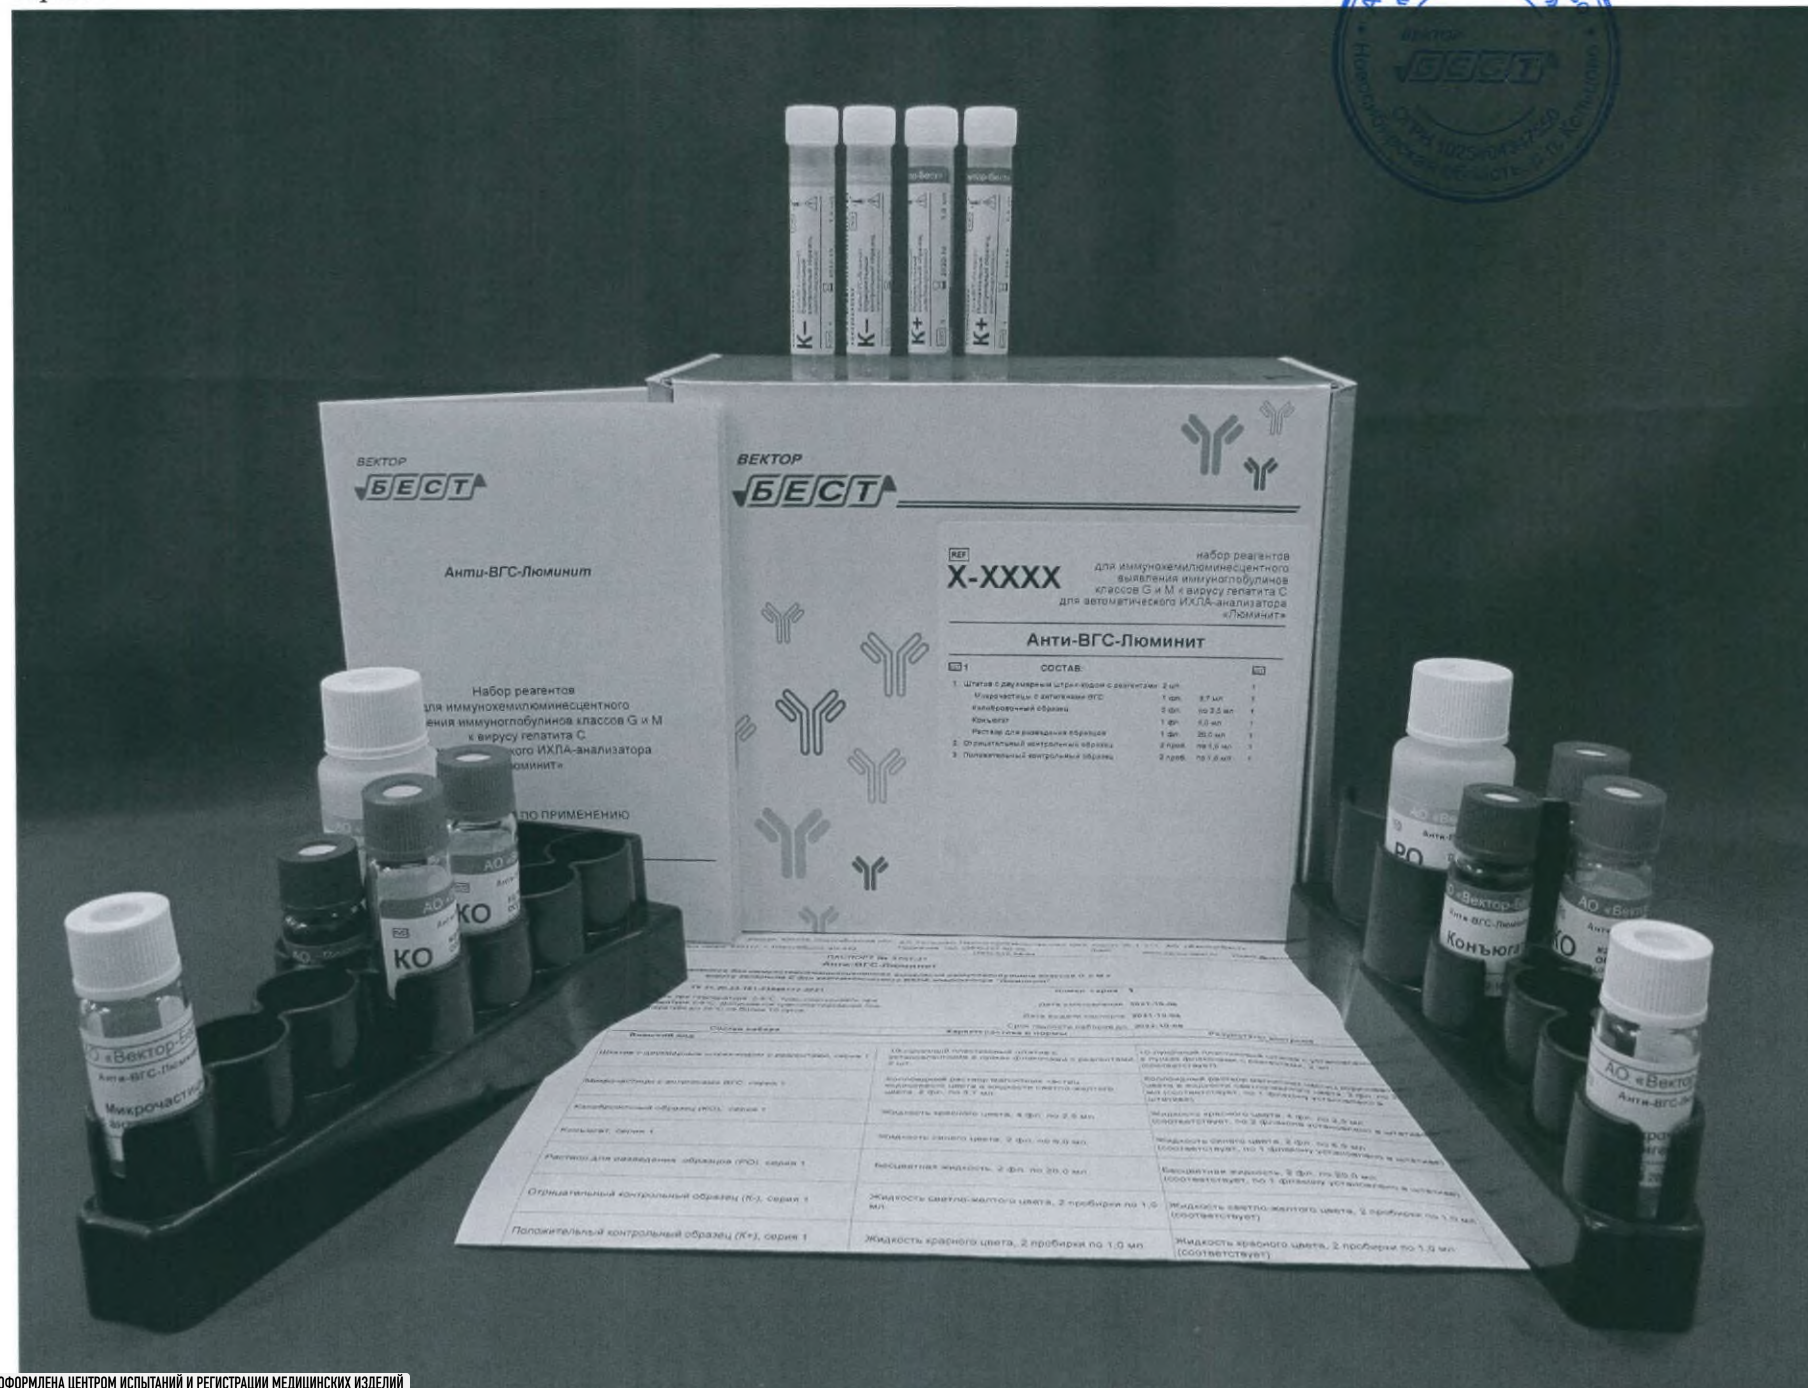

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“Анти-ВГС-Люминит” № 1
серия 1

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
2021 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
 «Анти-ВГС-Люминит» № 2
 серия 1



Генеральный директор
 АО «Вектор-Бест»
 М.Д. Хусанов
 «06» 10 2021 г.

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“Анти-ВГС-Люминит” № 3
серия 1

Генеральный директор
АО “Бектор-Бест”

М.Д. Хусаинов
2021 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“Анти-ВГС-Люминит” № 4
серия 1

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест”

М.Д. Хусаинов
2021 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“Анти-ВГС-Люминит” № 5
серия 1

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
“26” 10 2021 г.




Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“Анти-ВГС-Люминит” № 6
серия 1

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов

2021 г.



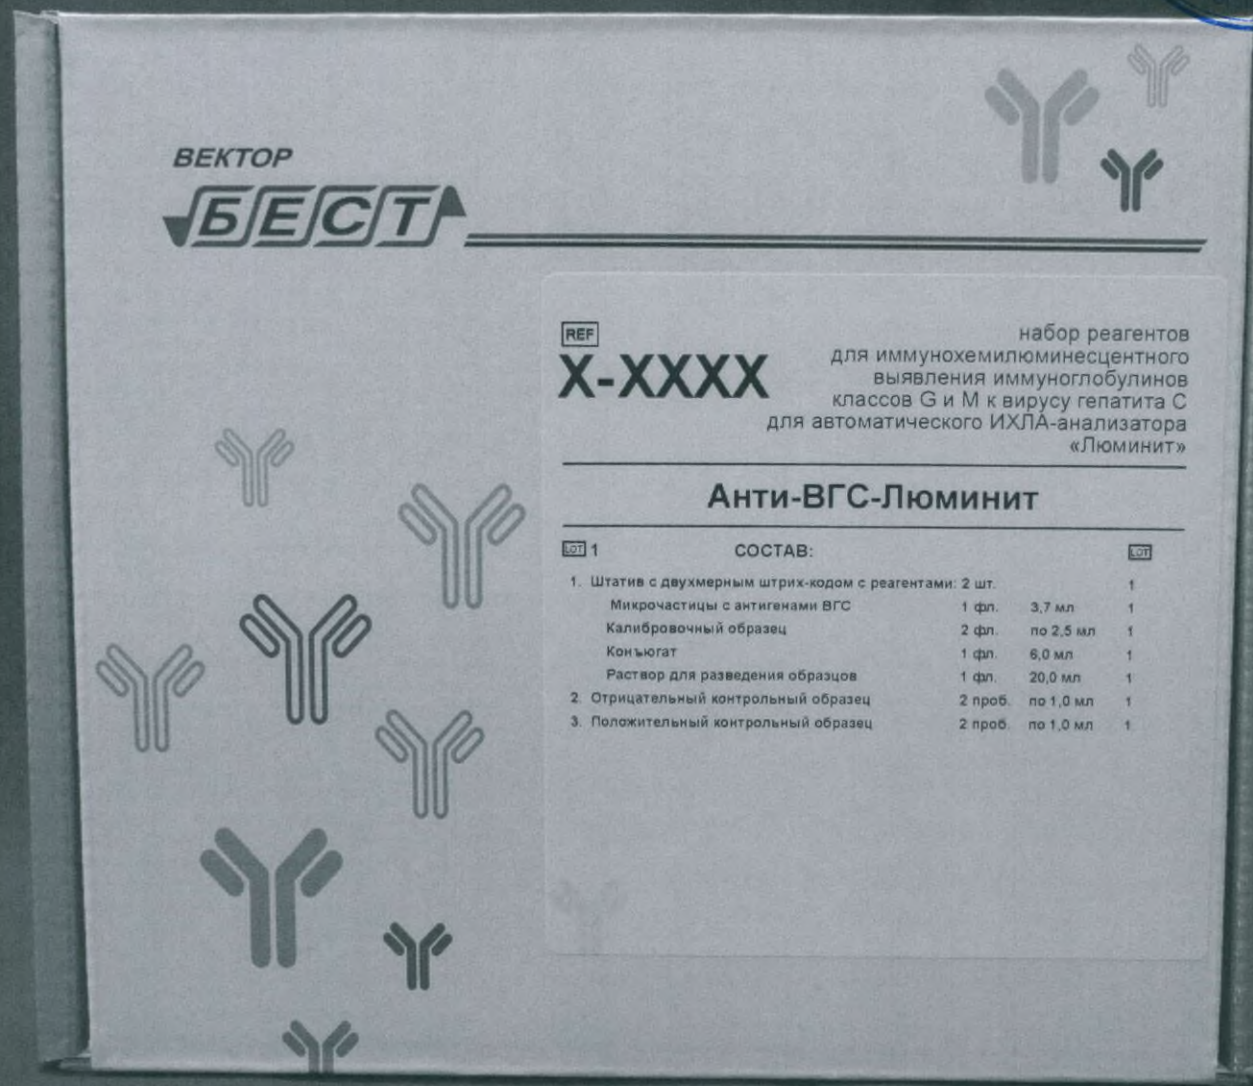


REF X-XXXX набор реагентов
для иммунохемилюминесцентного
выявления иммуноглобулинов
классов G и M к вирусу гепатита C
для автоматического ИХЛА-анализатора
«Люминит»

Анти-ВГС-Люминит

КОД 1	СОСТАВ:	КОД
1. Штатив с двухмерным штрих-кодом с реагентами: 2 шт.		1
Микрочастицы с антигенами ВГС	1 фл. 3,7 мл	1
Калибровочный образец	2 фл. по 2,5 мл	1
Конъюгат	1 фл. 6,0 мл	1
Раствор для разведения образцов	1 фл. 20,0 мл	1
2. Отрицательный контрольный образец	2 проб. по 1,0 мл	1
3. Положительный контрольный образец	2 проб. по 1,0 мл	1


Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
“Анти-ВГС-Люминит” № 2
серия 1

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
2021 г.

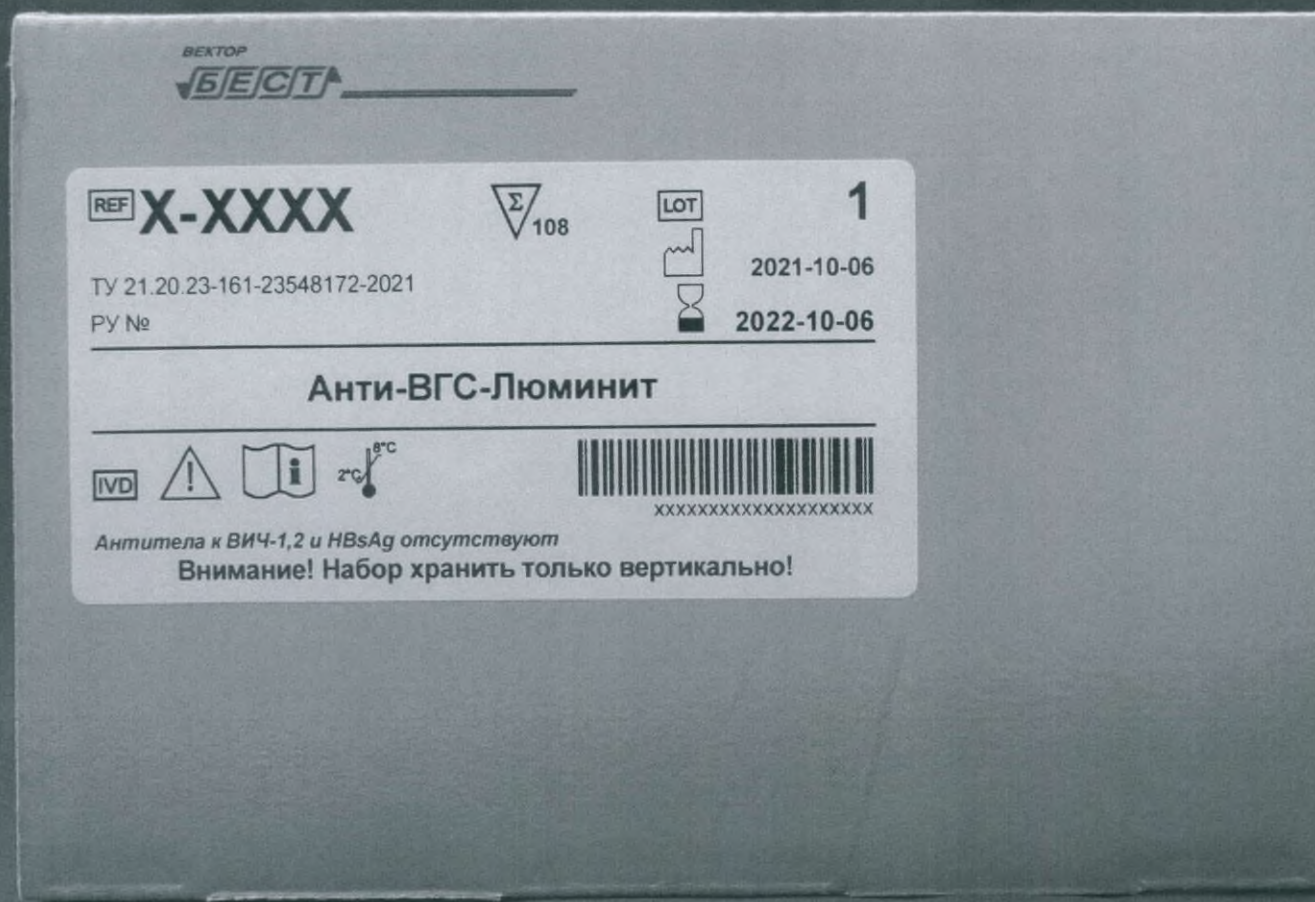


Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
“Анти-ВГС-Люминит” № 3
серия 1

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
2021 г.

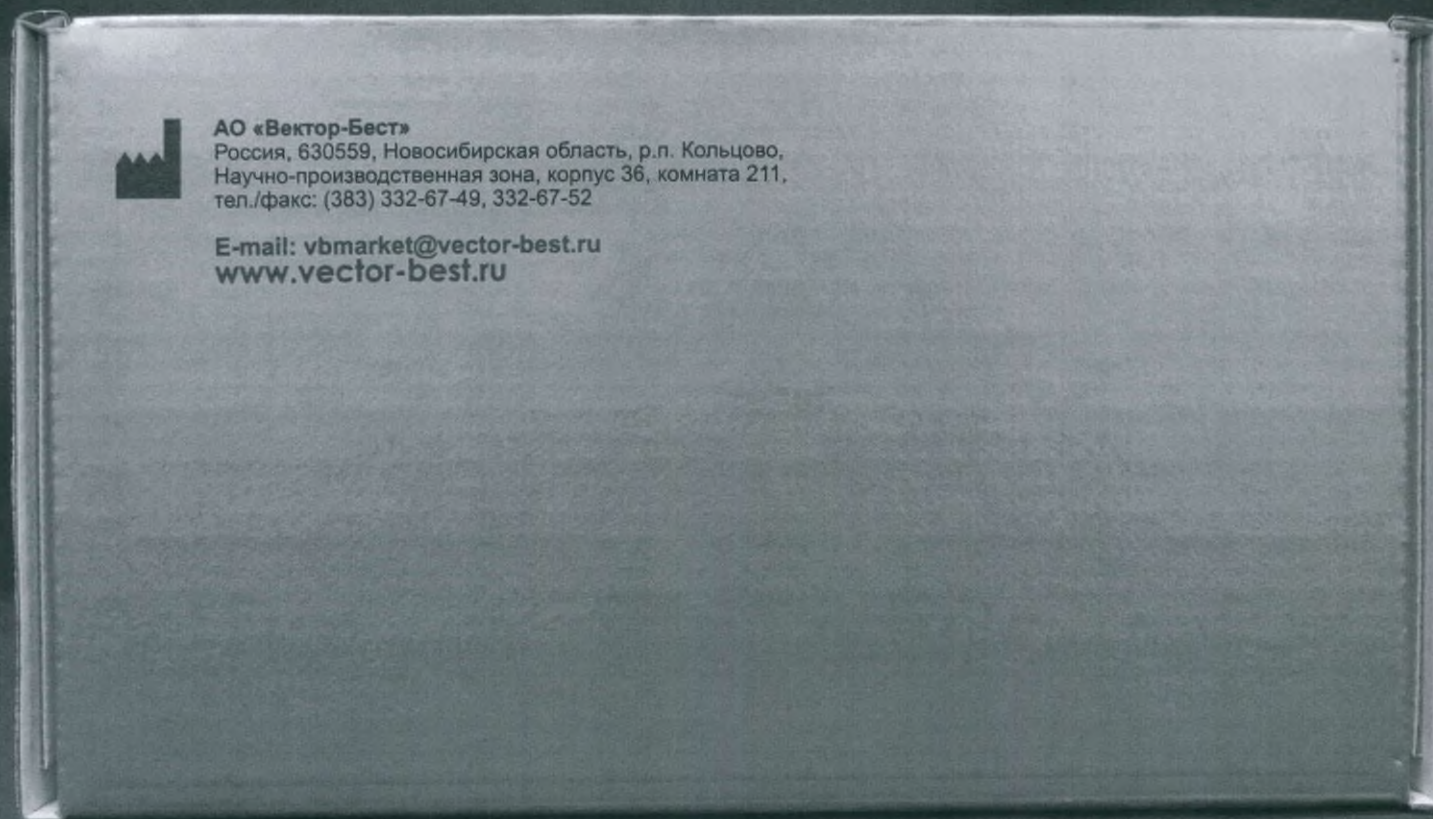

Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
 "Анти-ВГС-Люминит"
 серия 2

Генеральный директор
 АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусаинов
 2021 г.

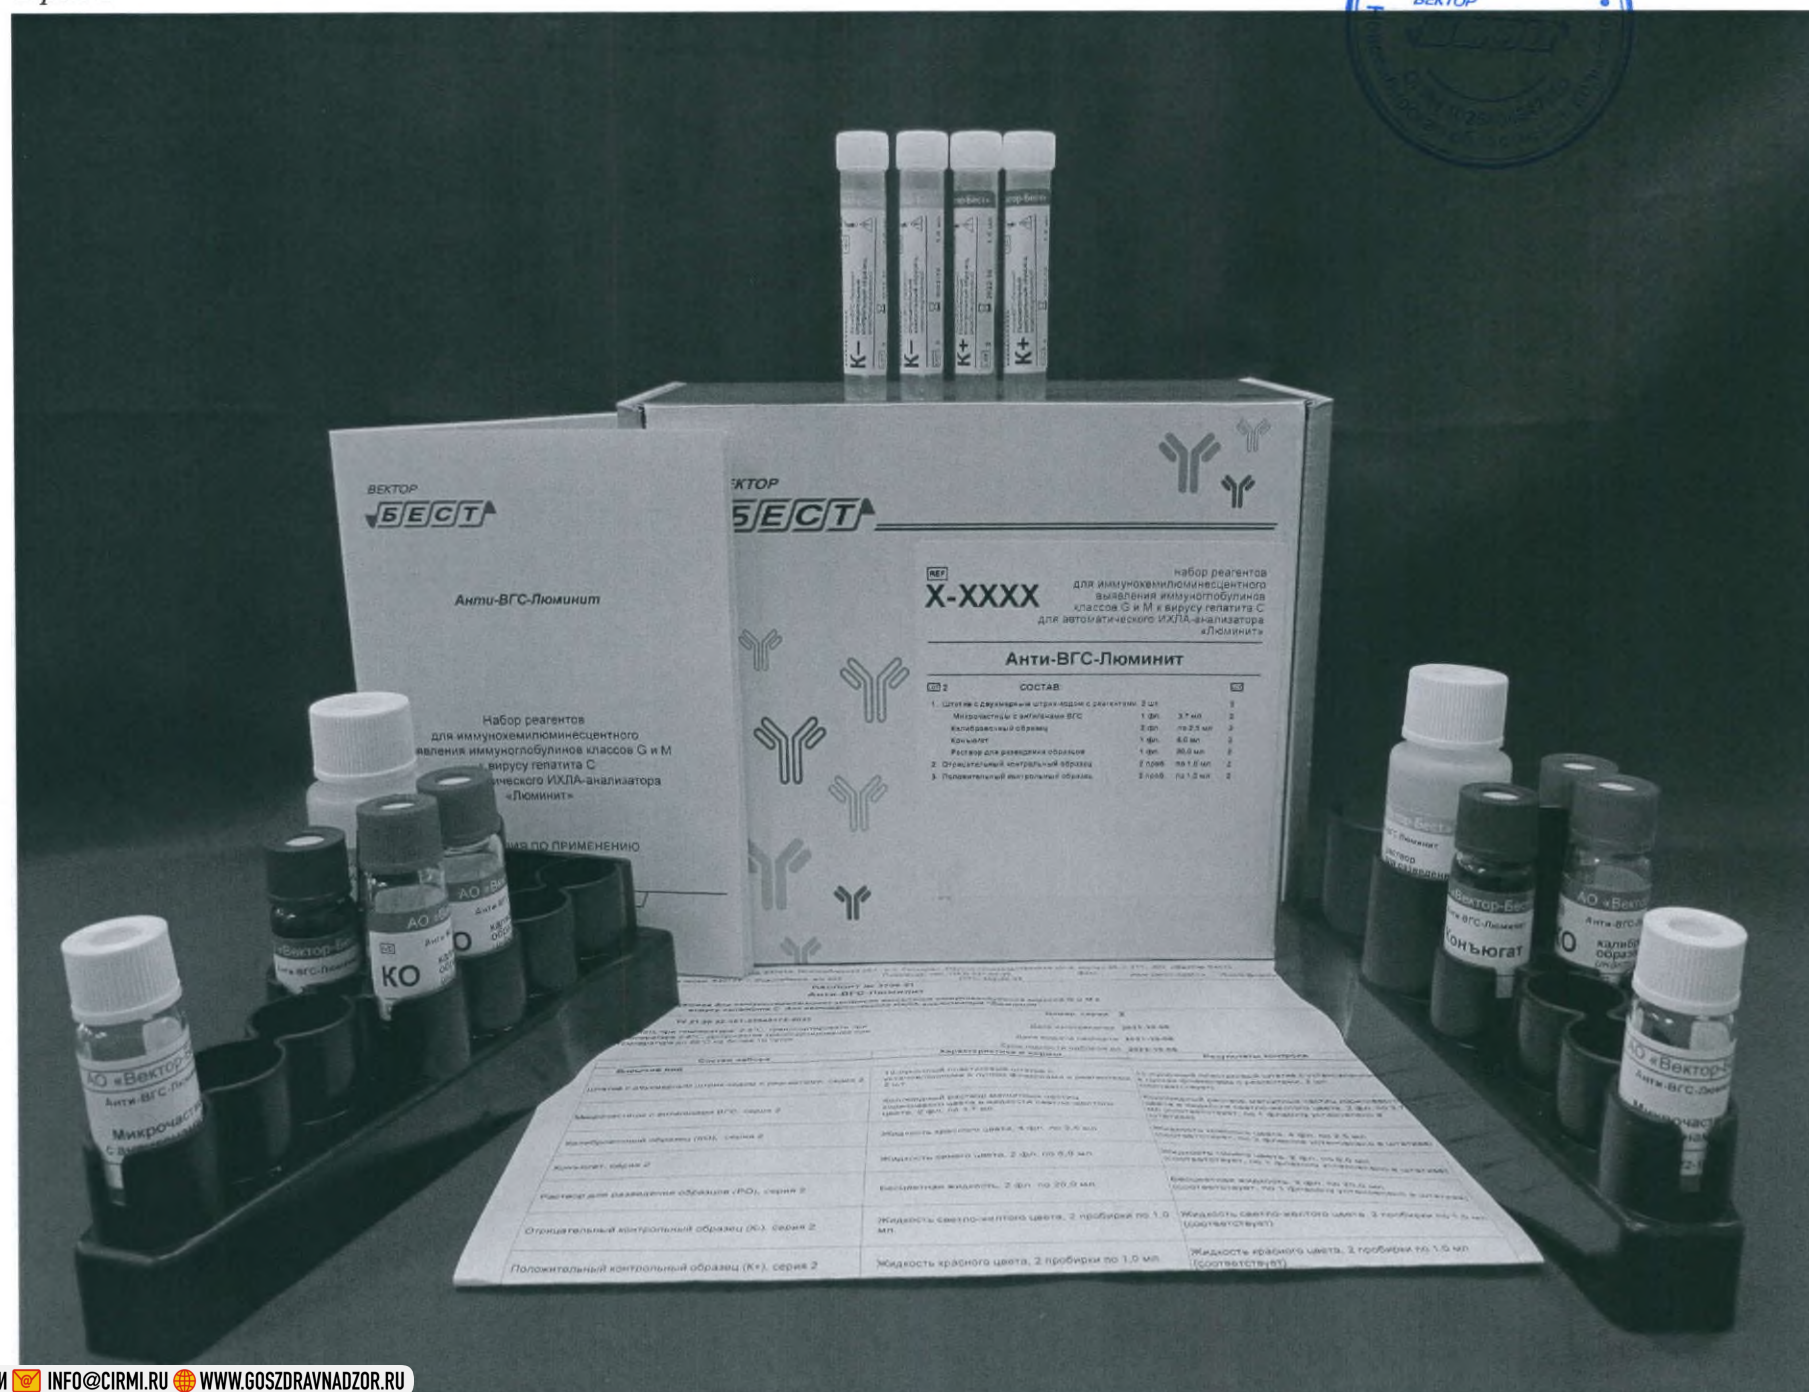

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“Анти-ВГС-Люминит” № 1
серия 2

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
2021 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
 «Анти-ВГС-Люминит» № 2
 серия 2



Генеральный директор
 АО «Вектор-Бест» М.Д. Хусаинов
 2021 г.

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“Анти-ВГС-Люминит” № 3
серия 2

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
“06” 10 2021 г.




Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“Анти-ВГС-Люминит” № 4
серия 2

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
“ 06 ” 2021 г.




Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“Анти-ВГС-Люминит” № 5
серия 2

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
“06” 10 / 2021 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
"Анти-ВГС-Люминит" № 6
серия 2

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусаинов
2021 г.

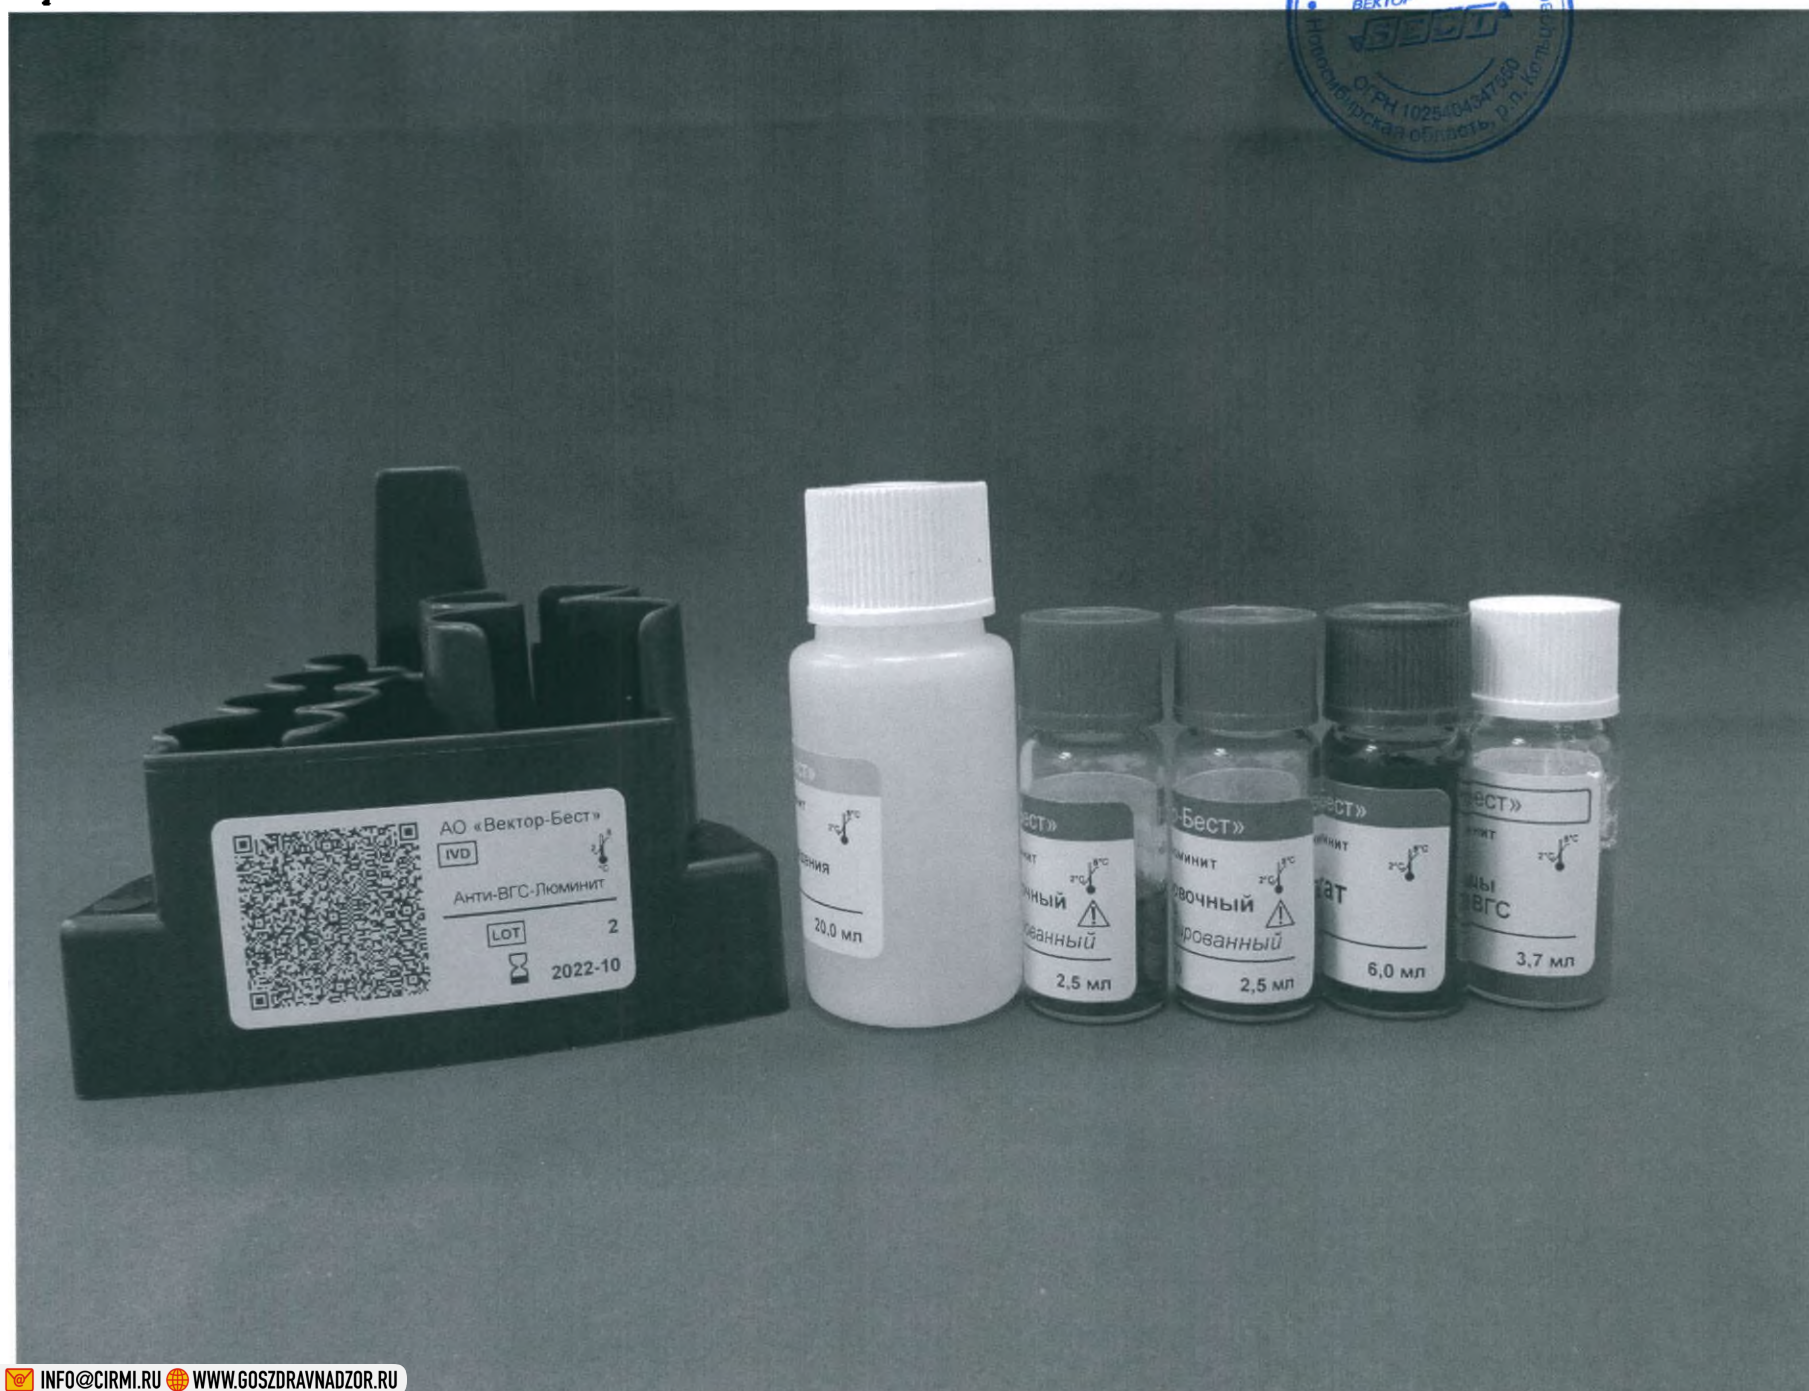



REF
X-XXXX


набор реагентов
 для иммунохемилюминесцентного
 выявления иммуноглобулинов
 классов G и M к вирусу гепатита С
 для автоматического ИХЛА-анализатора
 «Люминит»

Анти-ВГС-Люминит

LOT 2	СОСТАВ:			LOT
1. Штатив с двухмерным штрих-кодом с реагентами: 2 шт.				2
Микрочастицы с антигенами ВГС	1 фл.	3,7 мл		2
Калибровочный образец	2 фл.	по 2,5 мл		2
Конъюгат	1 фл.	6,0 мл		2
Раствор для разведения образцов	1 фл.	20,0 мл		2
2. Отрицательный контрольный образец	2 проб.	по 1,0 мл		2
3. Положительный контрольный образец	2 проб.	по 1,0 мл		2

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
“Анти-ВГС-Люминит” № 2
серия 2

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
“06” 2021 г.

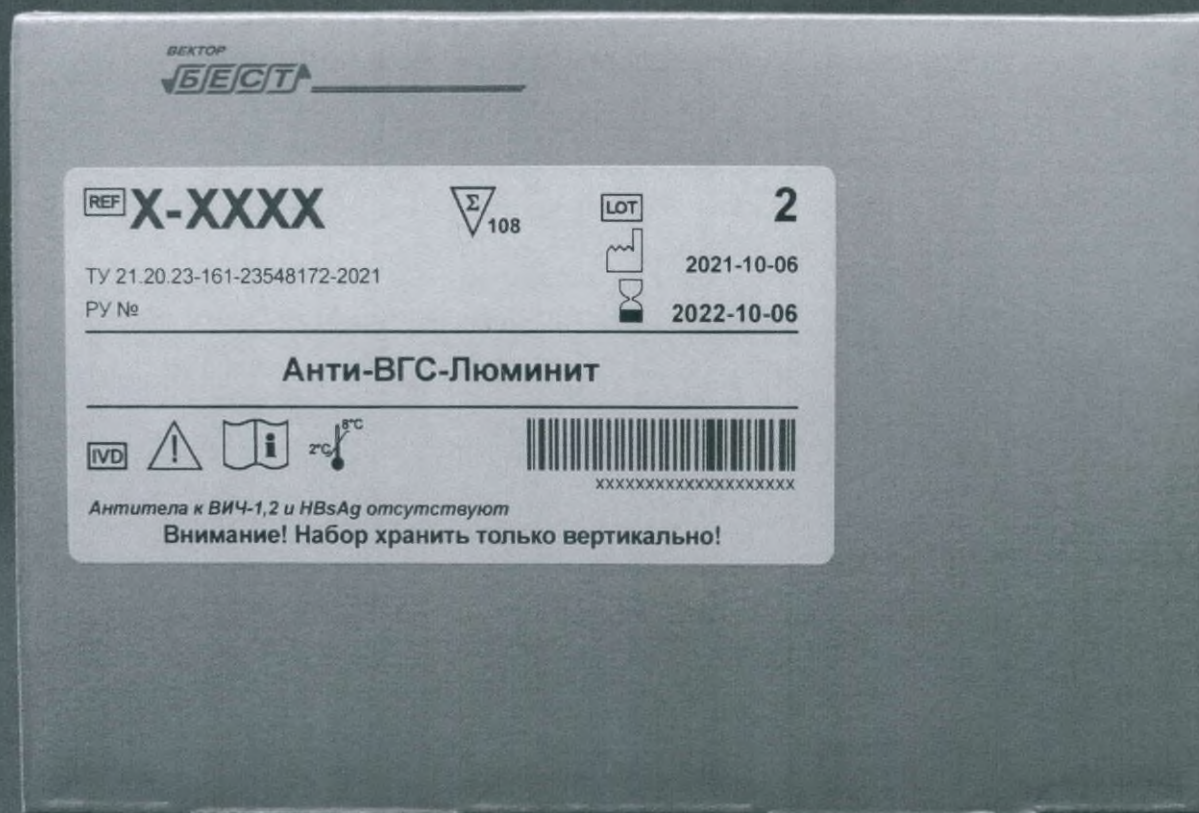


Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
“Анти-ВГС-Люминит” № 3
серия 2

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест”



М.Д. Хусаинов
2021 г.

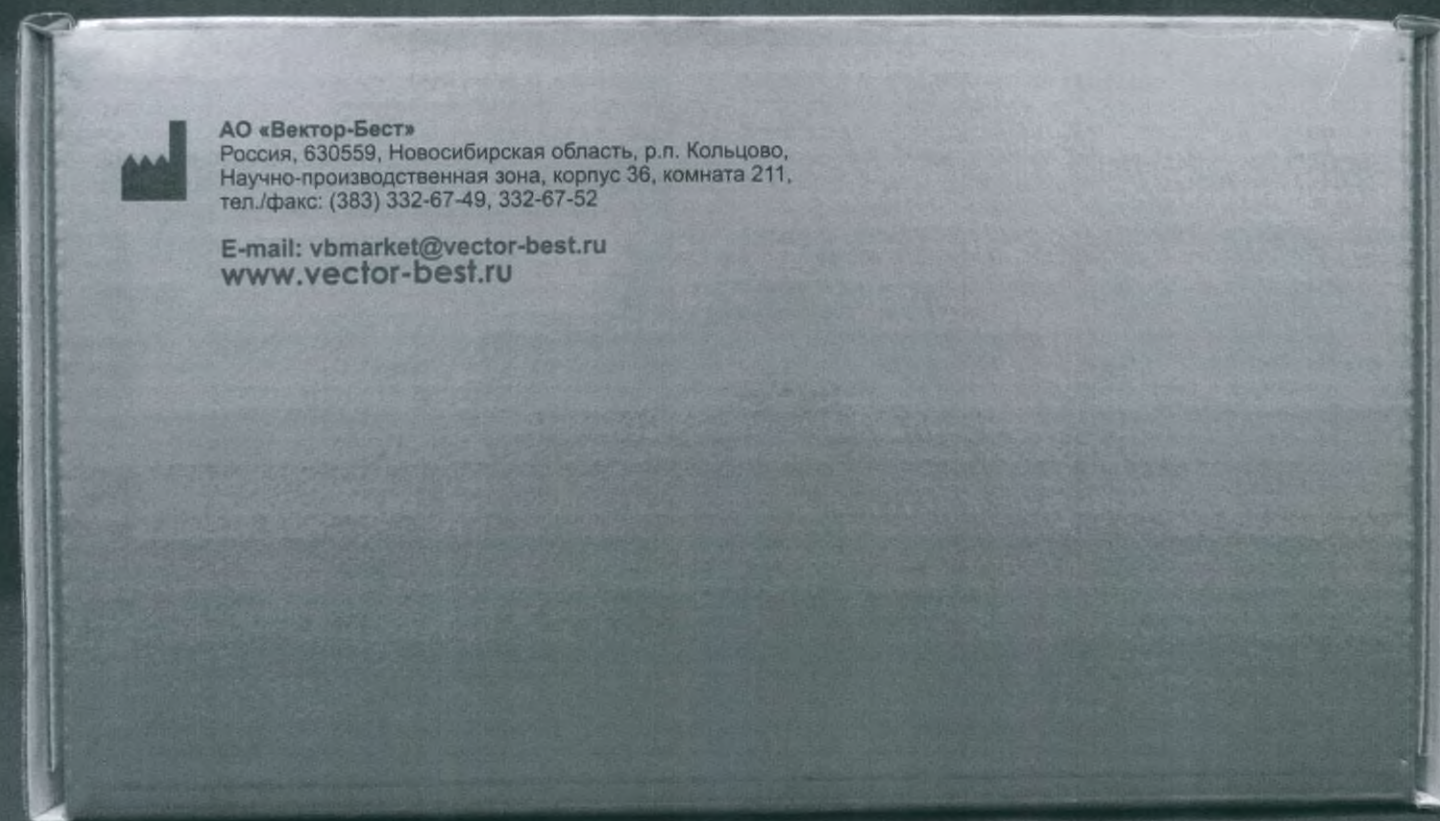

АО «Вектор-Бест»
Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово,
Научно-производственная зона, корпус 36, комната 211,
тел./факс: (383) 332-67-49, 332-67-52

E-mail: vbmarket@vector-best.ru
www.vector-best.ru



«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

М.Д. Хусаинов
2021 г.

**Образцы маркировки на Набор реагентов
для иммунохемилюминесцентного выявления
иммуноглобулинов классов G и M к вирусу гепатита С
для автоматического ИХЛА-анализатора «Люминит»
«Анти-ВГС-Люминит»**

1. Образцы этикеток на компоненты набора «Анти-ВГС-Люминит»

Наименование компонента	Этикетка
Штатив с двухмерным штрих-кодом с реагентами	
Микрочастицы с антигенами ВГС	
Калибровочный образец (КО)	
Конъюгат	
Раствор для разведения образцов (РО)	

Наименование компонента	Этикетка
Отрицательный контрольный образец (K-)	
Положительный контрольный образец (K+)	

2. Образцы этикеток на коробке набора «Анти-ВГС-Люминит»

2.1. Верхняя этикетка.

REF X-XXXX набор реагентов для иммунохемилюминесцентного выявления иммуноглобулинов классов G и M к вирусу гепатита C для автоматического ИХЛА-анализатора "Люминит"		
Анти-ВГС-Люминит		
LOT XXXX	Состав:	LOT
1. Штатив с двухмерным штрих-кодом с реагентами:	2 шт.	XXXX
Микрочастицы с антигенами ВГС	1 фл., 3,7 мл	XXXX
Калибровочный образец	2 фл. по 2,5 мл	XXXX
Конъюгат	1 фл., 6,0 мл	XXXX
Раствор для разведения образцов	1 фл., 20,0 мл	XXXX
2. Отрицательный контрольный образец	2 проб. по 1,0 мл	XXXX
3. Положительный контрольный образец	2 проб. по 1,0 мл	XXXX

2.2. Боковая этикетка № 1.

REF	X-XXXX	Σ 108	LOT	XXXX
ТУ 21.20.23-161-23548172-2021 РУ №			XXXX-XX-XX	XXXX-XX-XX
Анти-ВГС-Люминит				
IVD				
Антитела к ВИЧ-1,2 и HBsAg отсутствуют				
Внимание! Набор хранить только вертикально!				

2.3. Боковая этикетка № 2.

АО «Вектор-Бест»
Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово,
Научно-производственная зона, корпус 36, комната 211
тел/факс: (383) 252-51-64, 252-51-67
E-mail: vbmarket@vector-best.ru
www.vector-best.ru

Примечание. Текст боковой этикетки № 2 может быть нанесен непосредственно на коробку типографским способом.

«СОГЛАСОВАНО»
Директор НИИСД
АО «Вектор-Бест»

М.Ю. Рукавишников
«01» октября 2021 г.

«СОГЛАСОВАНО»
Директор по производству
АО «Вектор-Бест»

В.К. Ткачев
«01» октября 2021 г.

Прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью 3 листов.

Директор по технологии и качеству
АО «Вектор-Бест»



А.В. Масяго

“24” октября 2021 г.