



Генеральный директор
ООО "Асвомед"

Стройков С.П.

"23" мая 2019 г.

Фотографические изображения медицинского изделия:

Остеоденситометр рентгеновский STRATOS dR в вариантах исполнения с принадлежностями

г. Москва, 2019

Содержание


I. Остеоденситометр рентгеновский STRATOS dR с высокочастотным моноблоком 2,4 мА, в составе	4
1. Остеоденситометр рентгеновский STRATOS dR	4
2. Кабель питания	5
3. Сетевой кабель LAN (5 м, кат.5Е)	6
4. Фантом спины (3ROI) для калибровки	7
5. Матрас пациента	8
6. Подушка для позиционирования ног при сканировании спины	9
7. Фиксатор для ног при сканировании бедра	10
8. Комплект специальных подушек для сканирования на боку	11
- подушка для позиционирования при цифровой оценке позвоночника (DVA) на боку	11
- подушка для позиционирования при сканировании спины на боку (боковой BMD)	11
9. Программное обеспечение на CD-диске	12
10. Руководство пользователя на CD-диске	13
II. Остеоденситометр рентгеновский STRATOS dR с высокочастотным моноблоком 2,5 мА, в составе	14
1. Остеоденситометр рентгеновский STRATOS dR	14
2. Кабель питания	15
3. Сетевой кабель LAN (5 м, кат.5Е)	16
4. Фантом спины (3ROI) для калибровки	17
5. Матрас пациента	18
6. Подушка для позиционирования ног при сканировании спины	19
7. Фиксатор для ног при сканировании бедра	20
8. Комплект специальных подушек для сканирования на боку	21
- подушка для позиционирования при цифровой оценке позвоночника (DVA) на боку	21
- подушка для позиционирования при сканировании спины на боку (боковой BMD)	21
9. Программное обеспечение на CD-диске	22
10. Руководство пользователя на CD-диске	23
III. Остеоденситометр рентгеновский STRATOS dR с высокочастотным моноблоком 3 мА, в составе	24
1. Остеоденситометр рентгеновский STRATOS dR	24
2. Кабель питания	25
3. Сетевой кабель LAN (5 м, кат.5Е)	26
4. Фантом спины (3ROI) для калибровки	27
5. Матрас пациента	28
6. Подушка для позиционирования ног при сканировании спины	29
7. Фиксатор для ног при сканировании бедра	30
8. Комплект специальных подушек для сканирования на боку	31
- подушка для позиционирования при цифровой оценке позвоночника (DVA) на боку	31
- подушка для позиционирования при сканировании спины на боку (боковой BMD)	31

9. Программное обеспечение на CD-диске	32
10. Руководство пользователя на CD-диске	33
IV. Остеоденситометр рентгеновский STRATOS dR с высокочастотным моноблоком 3,2 мА в составе	34
1. Остеоденситометр рентгеновский STRATOS dR	34
2. Кабель питания	35
3. Сетевой кабель LAN (5 м, кат.5Е)	36
4. Фантом спины (3ROI) для калибровки	37
5. Матрас пациента	38
6. Подушка для позиционирования ног при сканировании спины	39
7. Фиксатор для ног при сканировании бедра	40
8. Комплект специальных подушек для сканирования на боку	41
- подушка для позиционирования при цифровой оценке позвоночника (DVA) на боку	41
- подушка для позиционирования при сканировании спины на боку (боковой BMD)	41
9. Программное обеспечение на CD-диске	42
10. Руководство пользователя на CD-диске	43
V. Принадлежности	44
Модуль 3D-DXA реконструкции бедренной кости в составе	44
- модуль 3D-DXA на базе специализированного компьютера	44
- кабель питания для модуля	45
- сетевой кабель LAN (3 м, кат.6Е)	46
- лицензионный USB-ключ	47

I. Остеоденситометр рентгеновский STRATOS dR с высокочастотным моноблоком 2,4 мА, в составе:




1. Остеоденситометр рентгеновский STRATOS dR

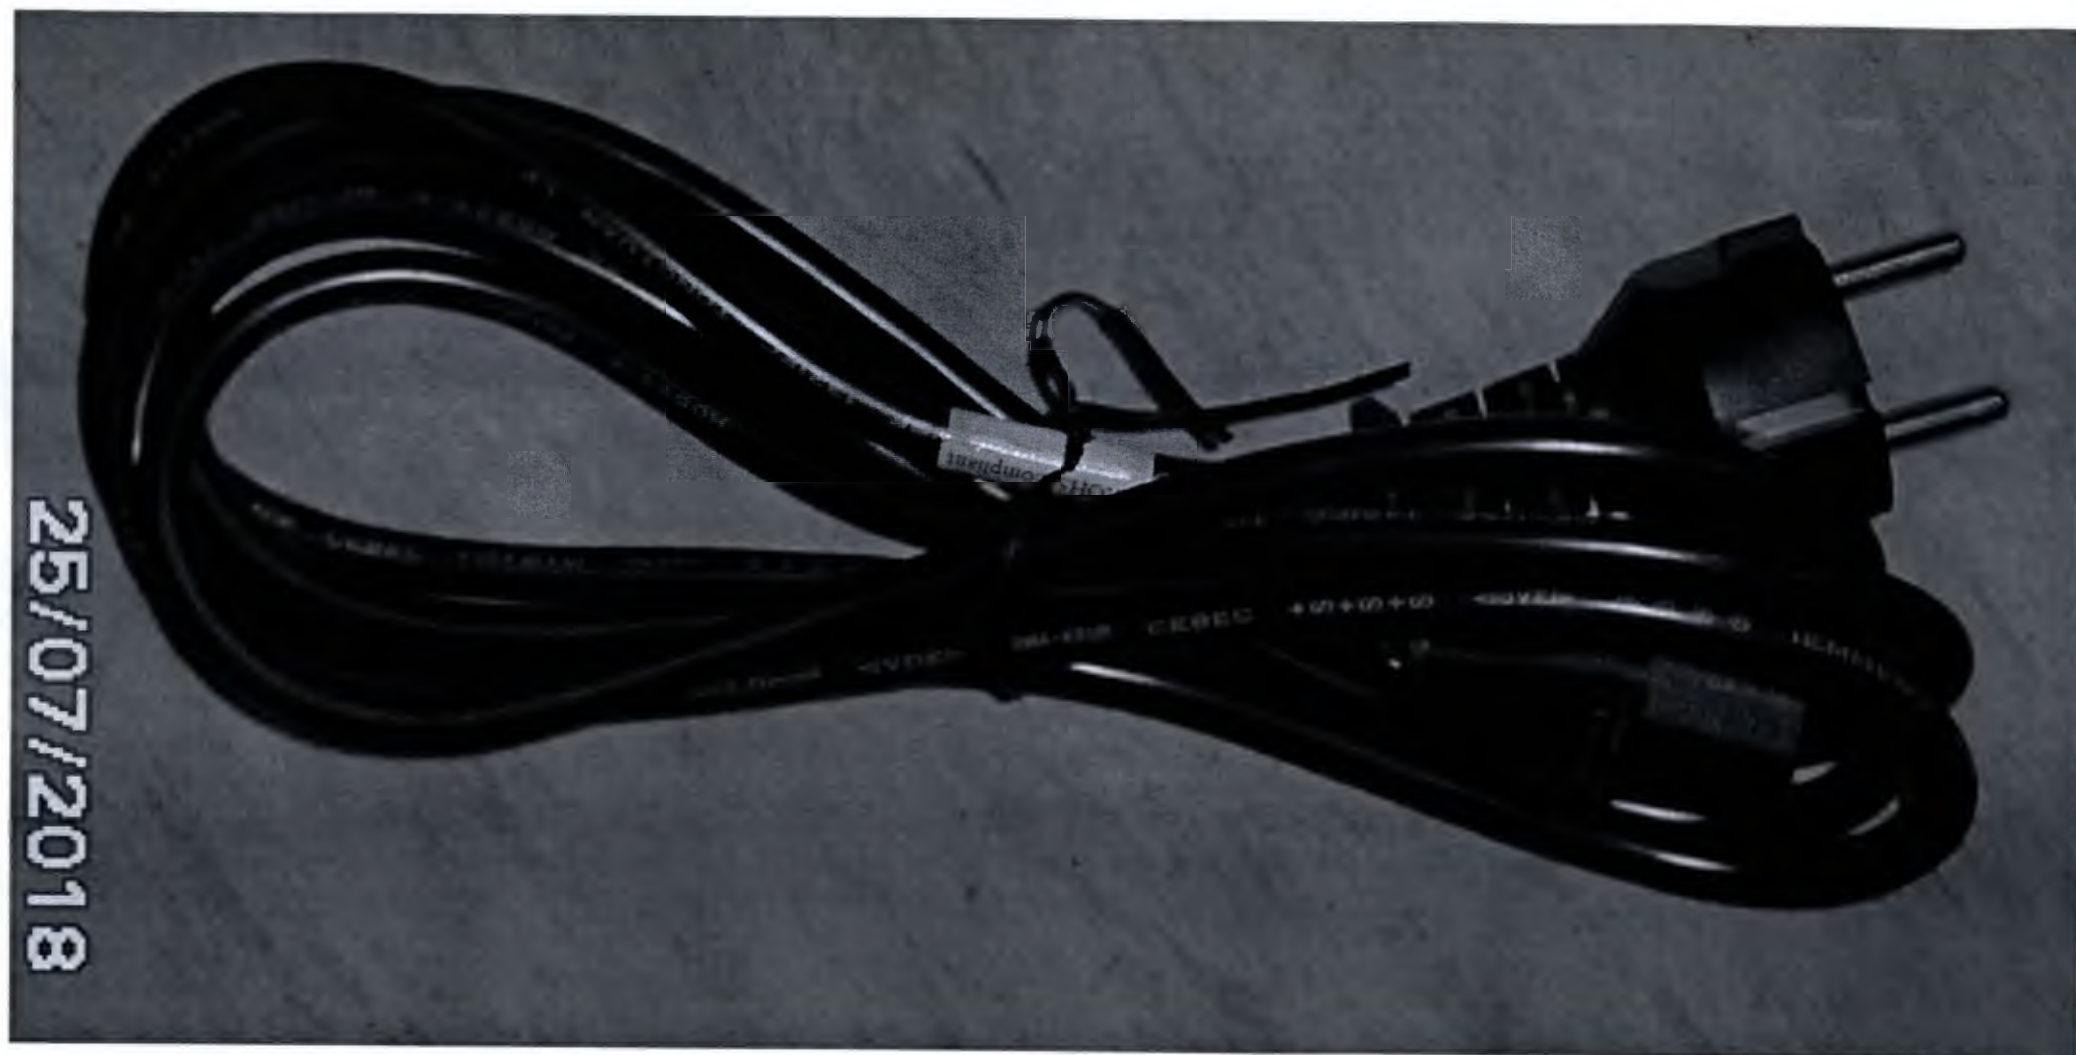


2. Кабель питания




3. Сетевой кабель LAN (5м, кат.5Е)

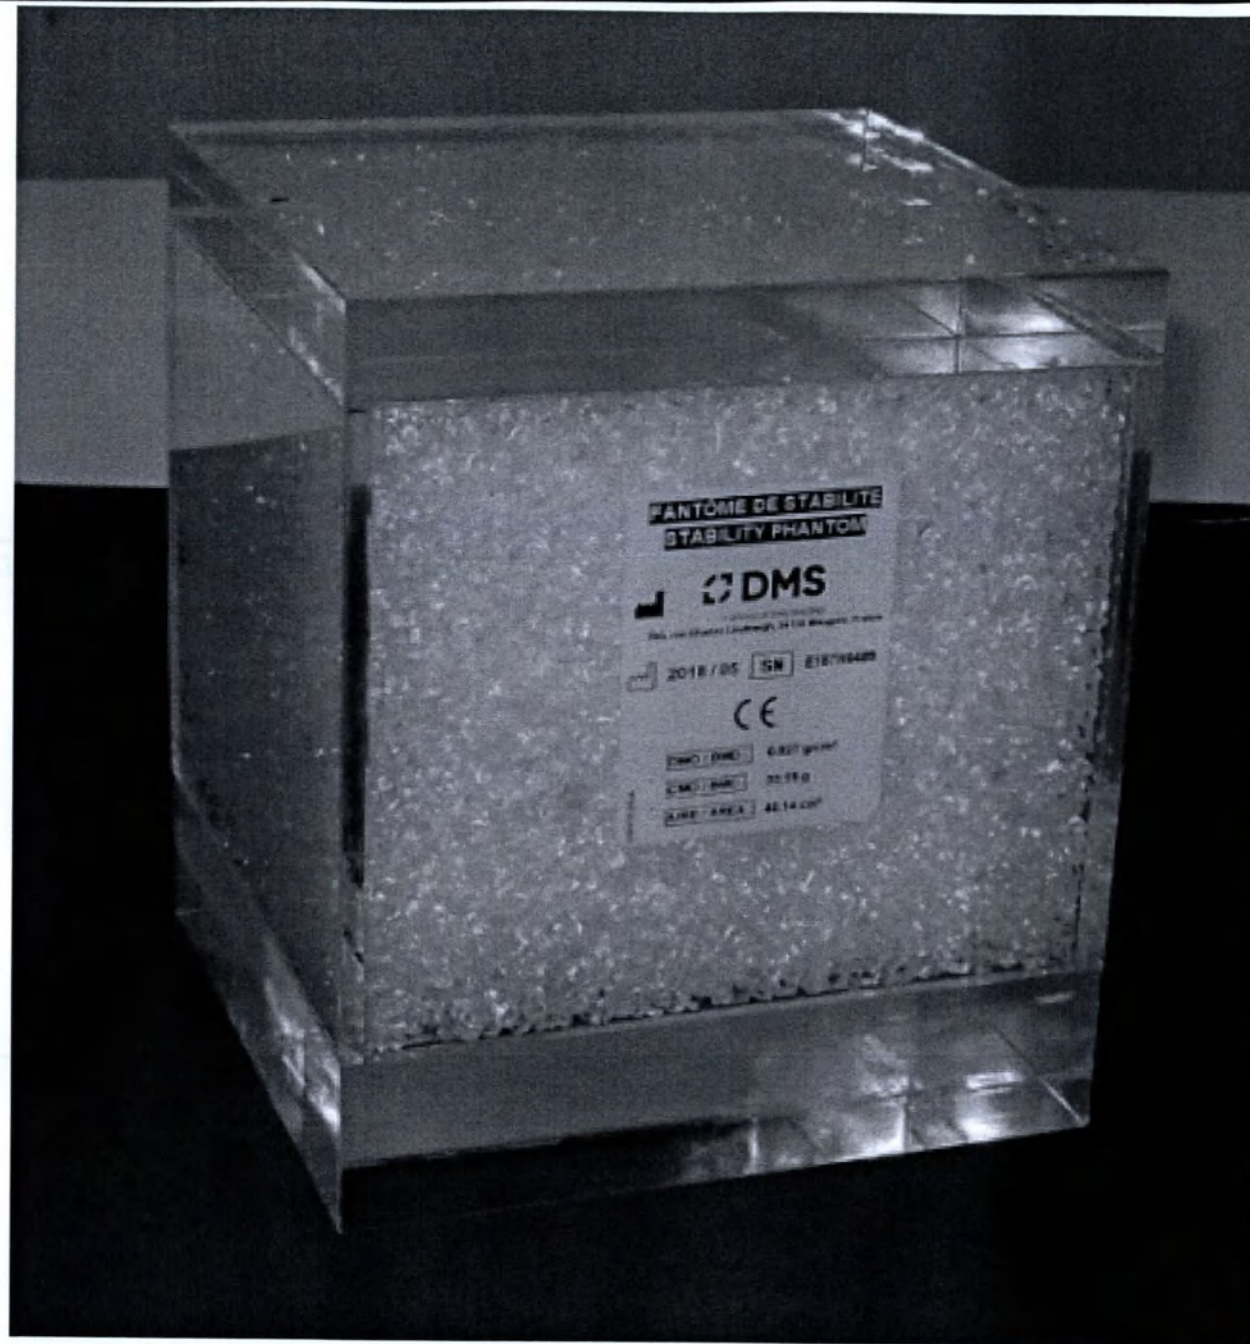


4. Фантом спины (ЗРОІ) для калибровки

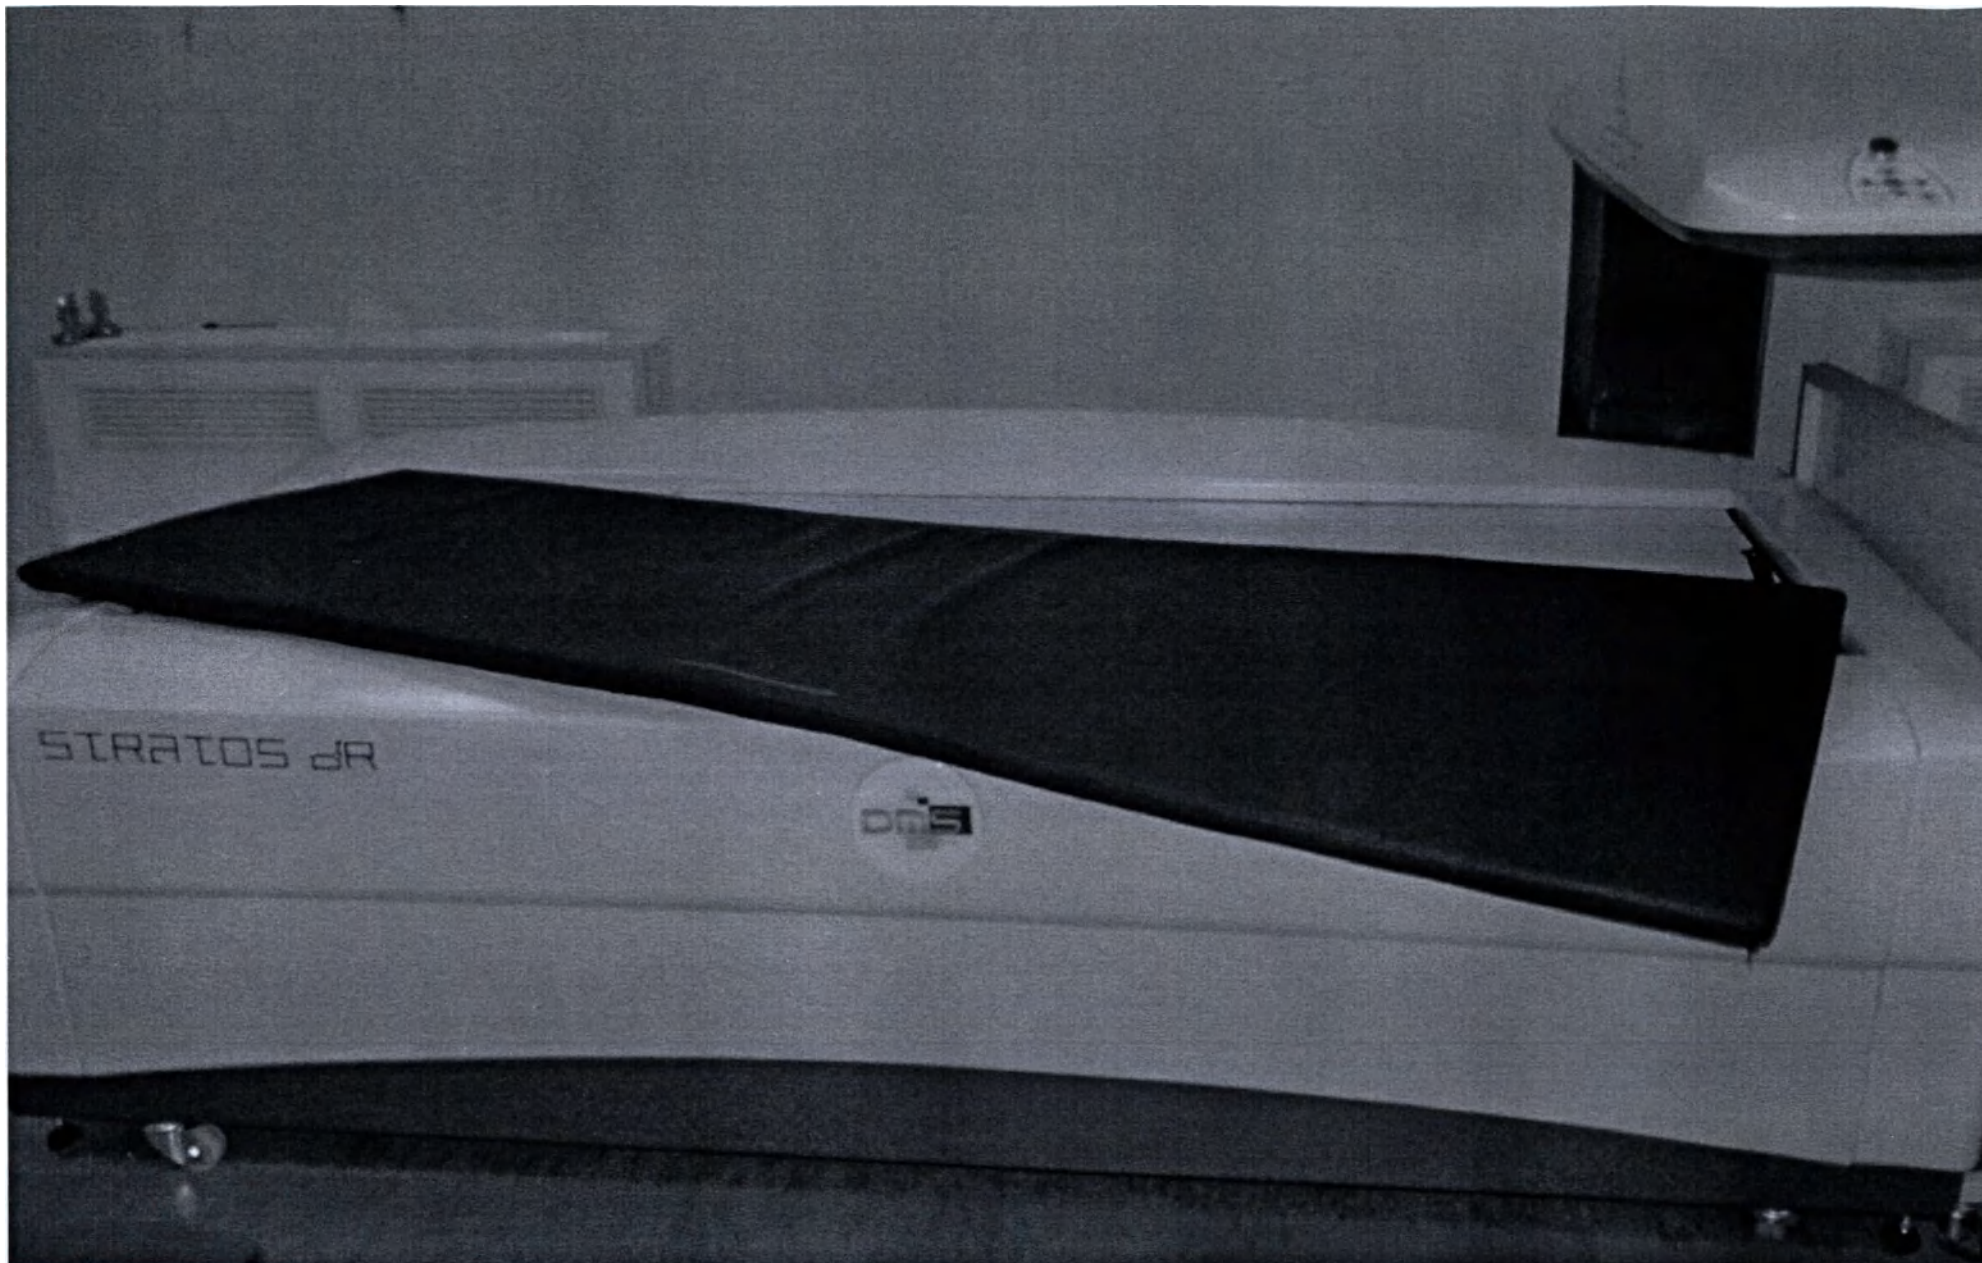


5. Матрас пациента

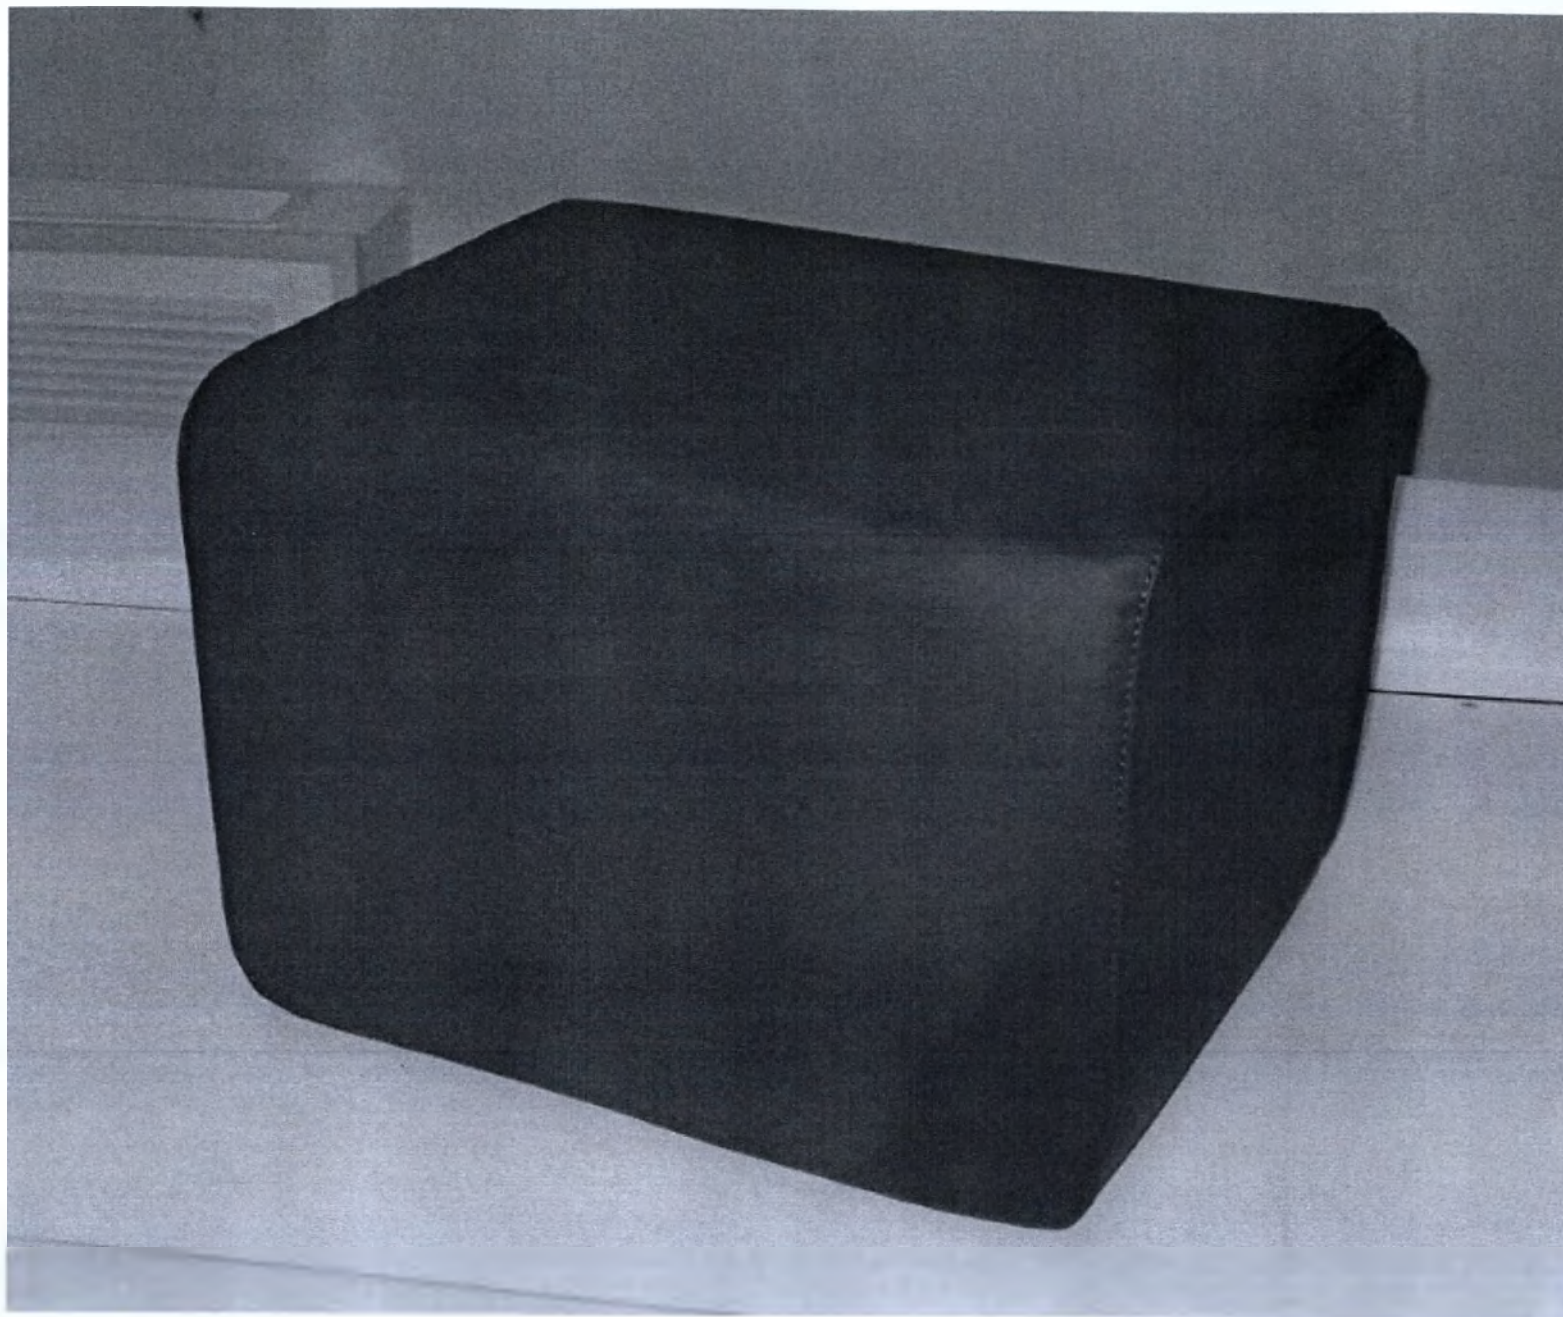

6. Подушка для позиционирования ног при сканировании спины

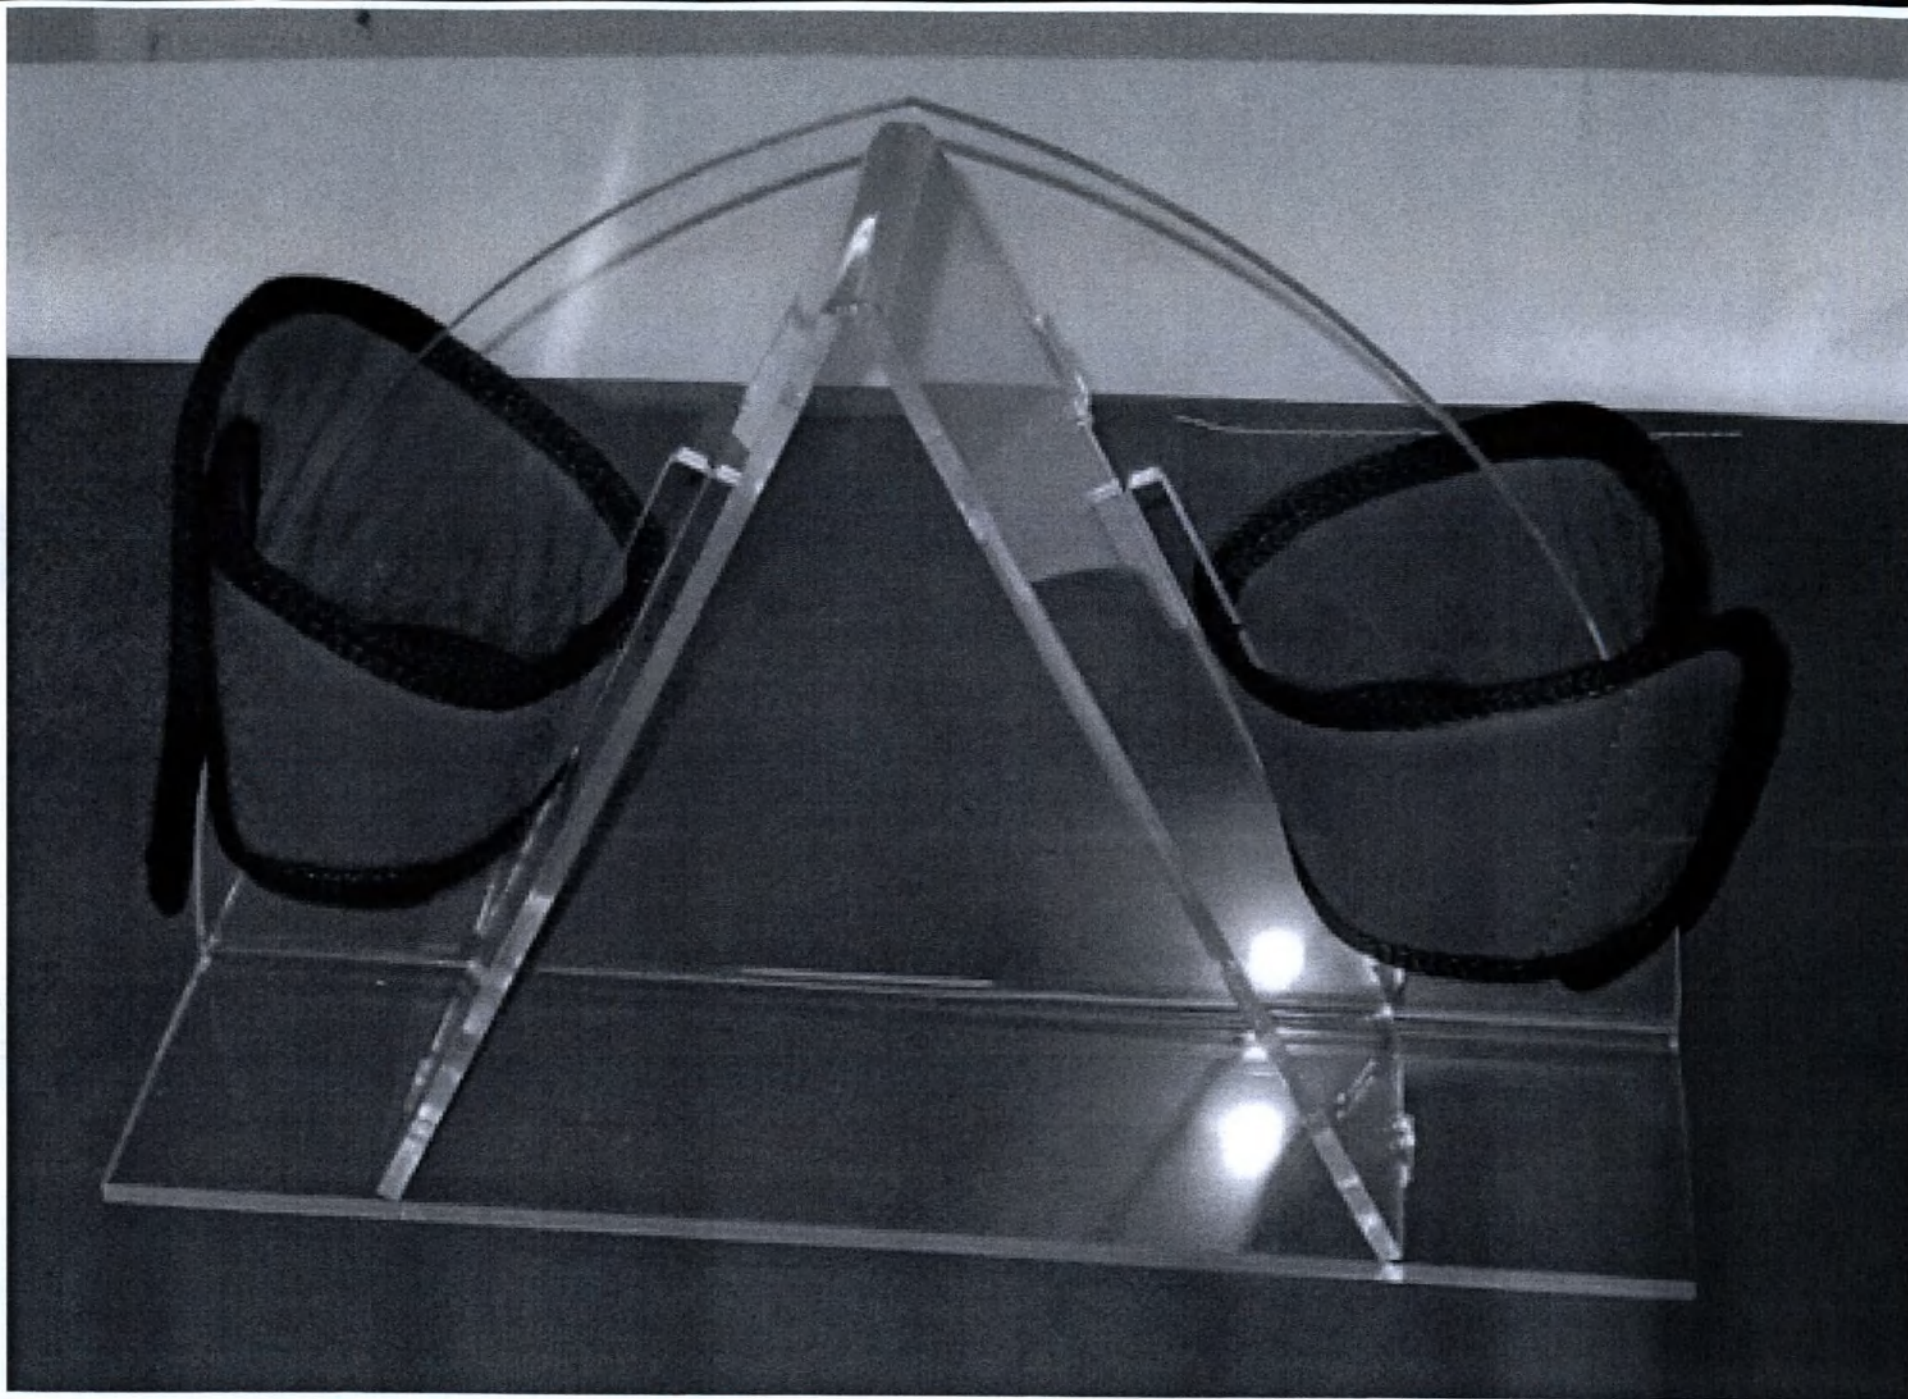

7. Фиксатор для ног при сканировании бедра

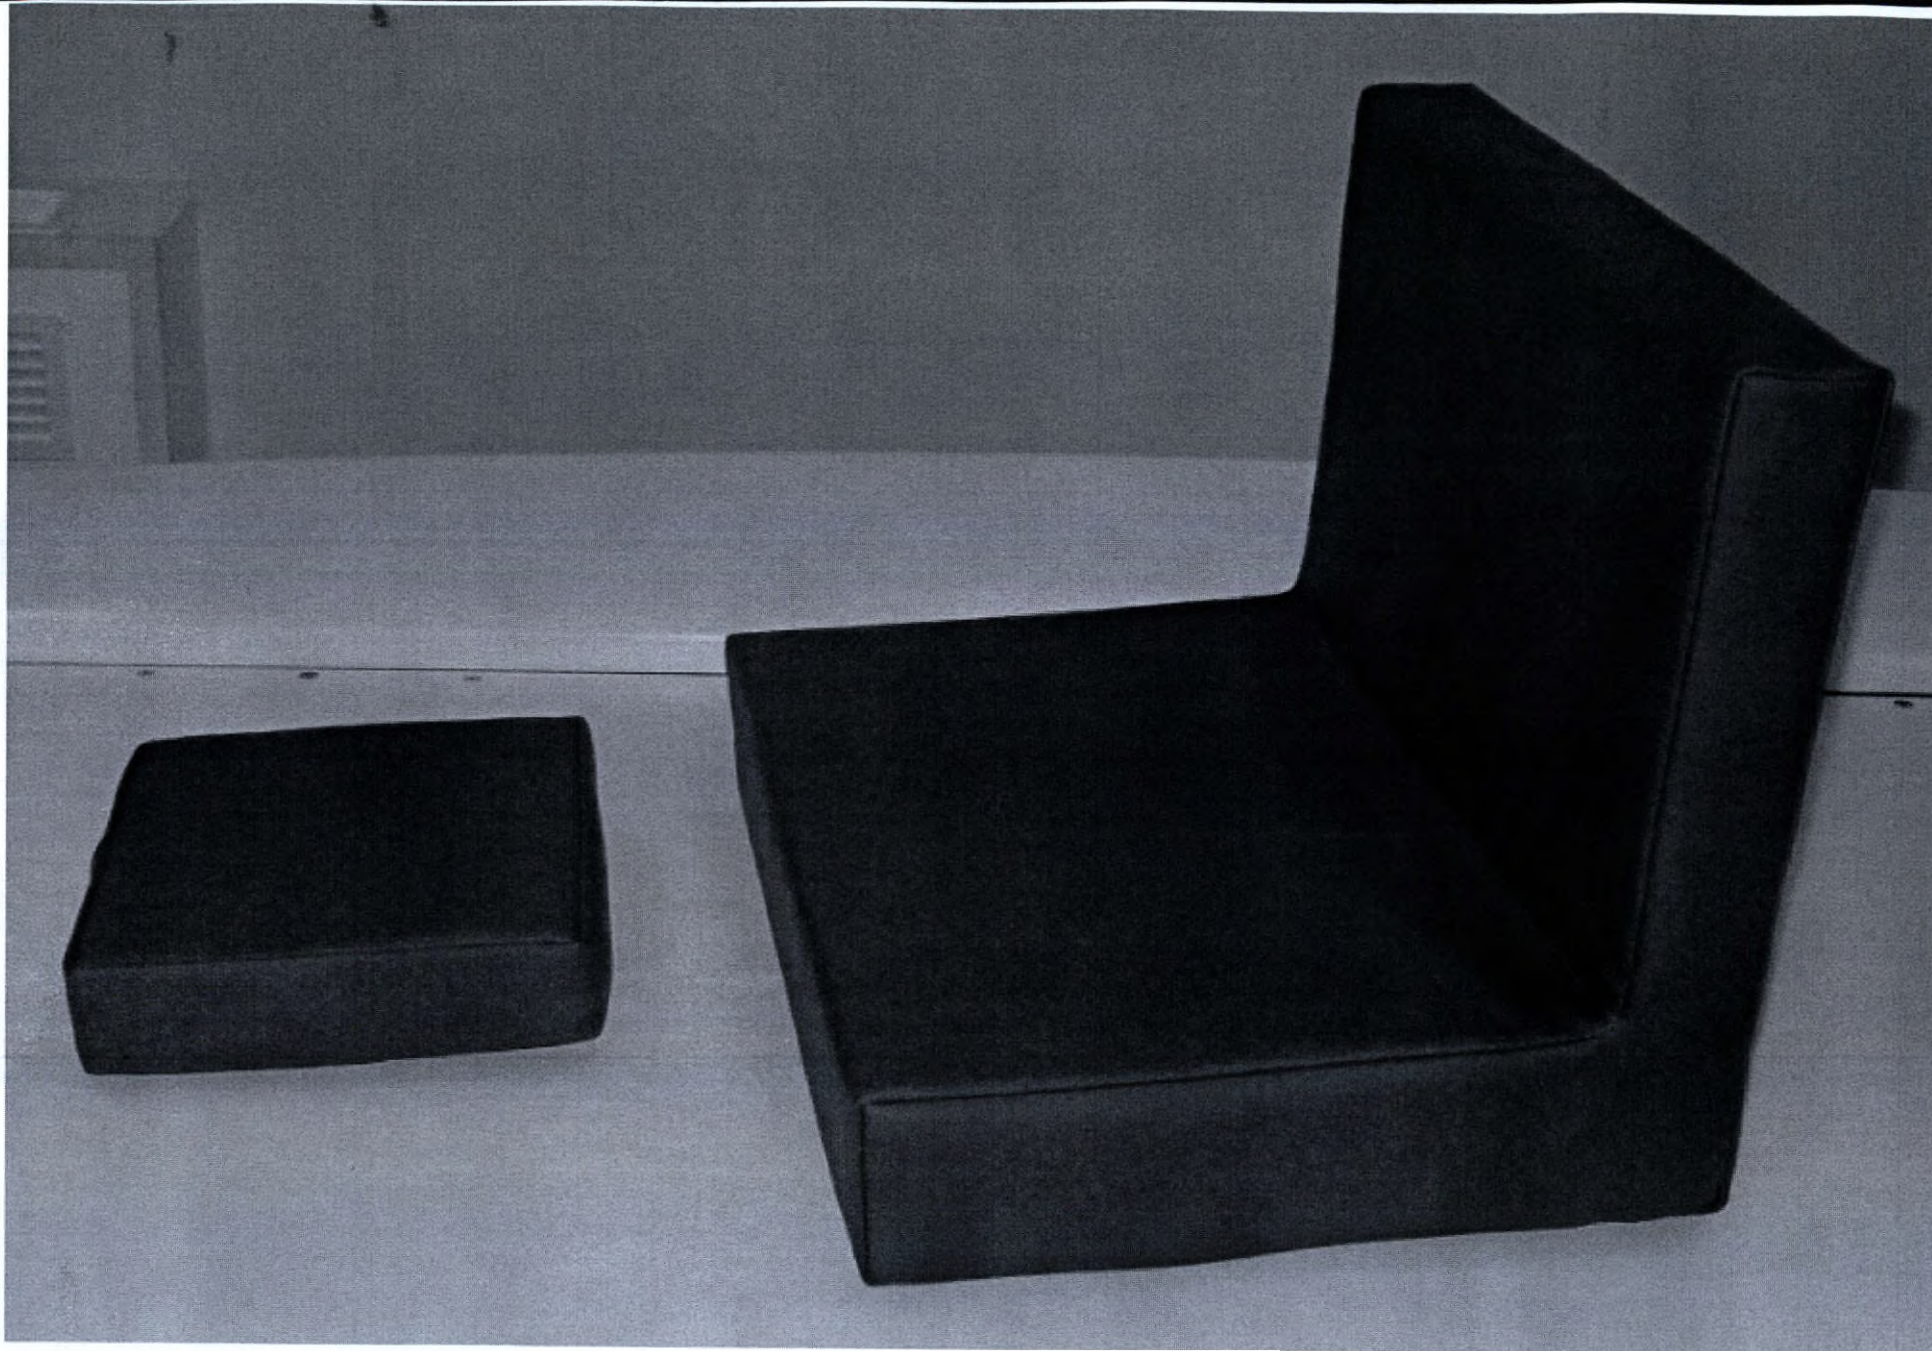

8. Комплект специальных подушек для сканирования на боку:
- подушка для позиционирования при цифровой оценке позвоночника (DVA) на боку; подушка для позиционирования при сканировании спины на боку (боковой BMD)



9. Программное обеспечение на CD-диске




10. Руководство пользователя на CD-диске

II. Остеоденситометр рентгеновский STRATOS dR с высокочастотным моноблоком 2,5 МА, в составе:



1. Остеоденситометр рентгеновский STRATOS dR

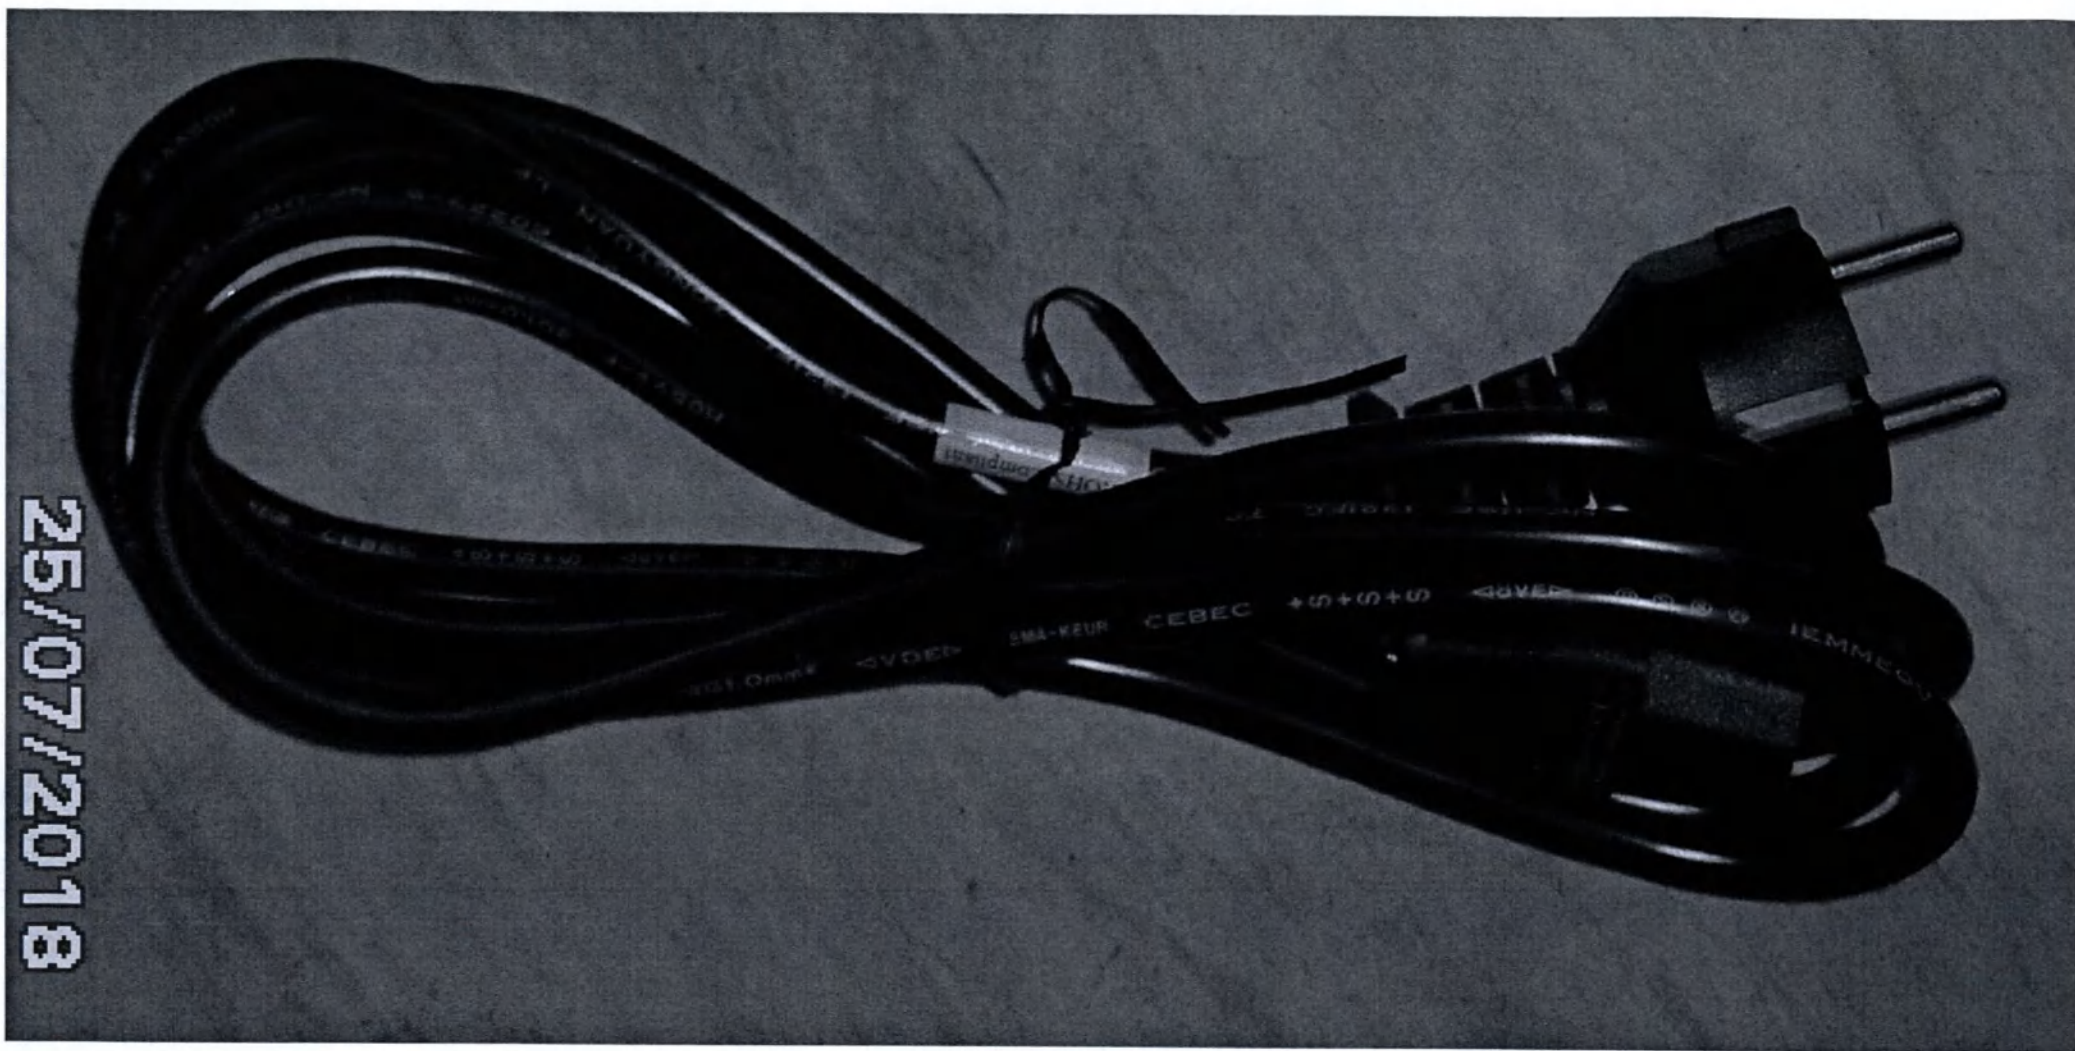


25/07/2018


2. Кабель питания




3. Сетевой кабель LAN (5м, кат.5Е)

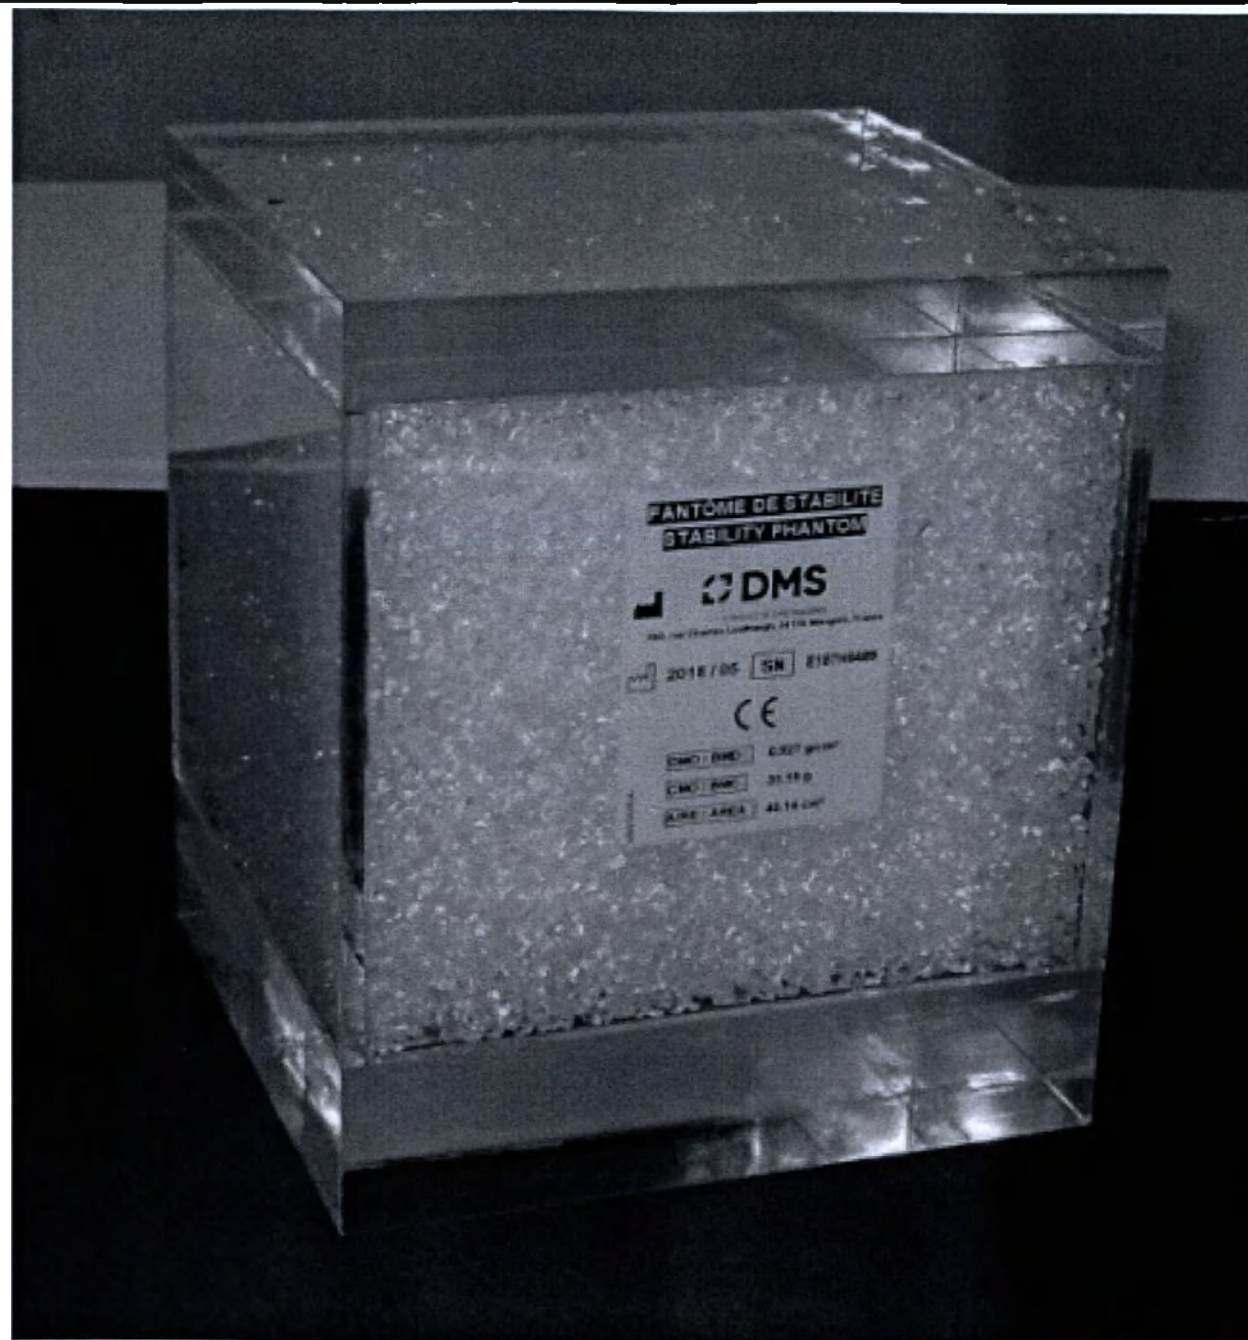


4. Фантом спины (3ROI) для калибровки

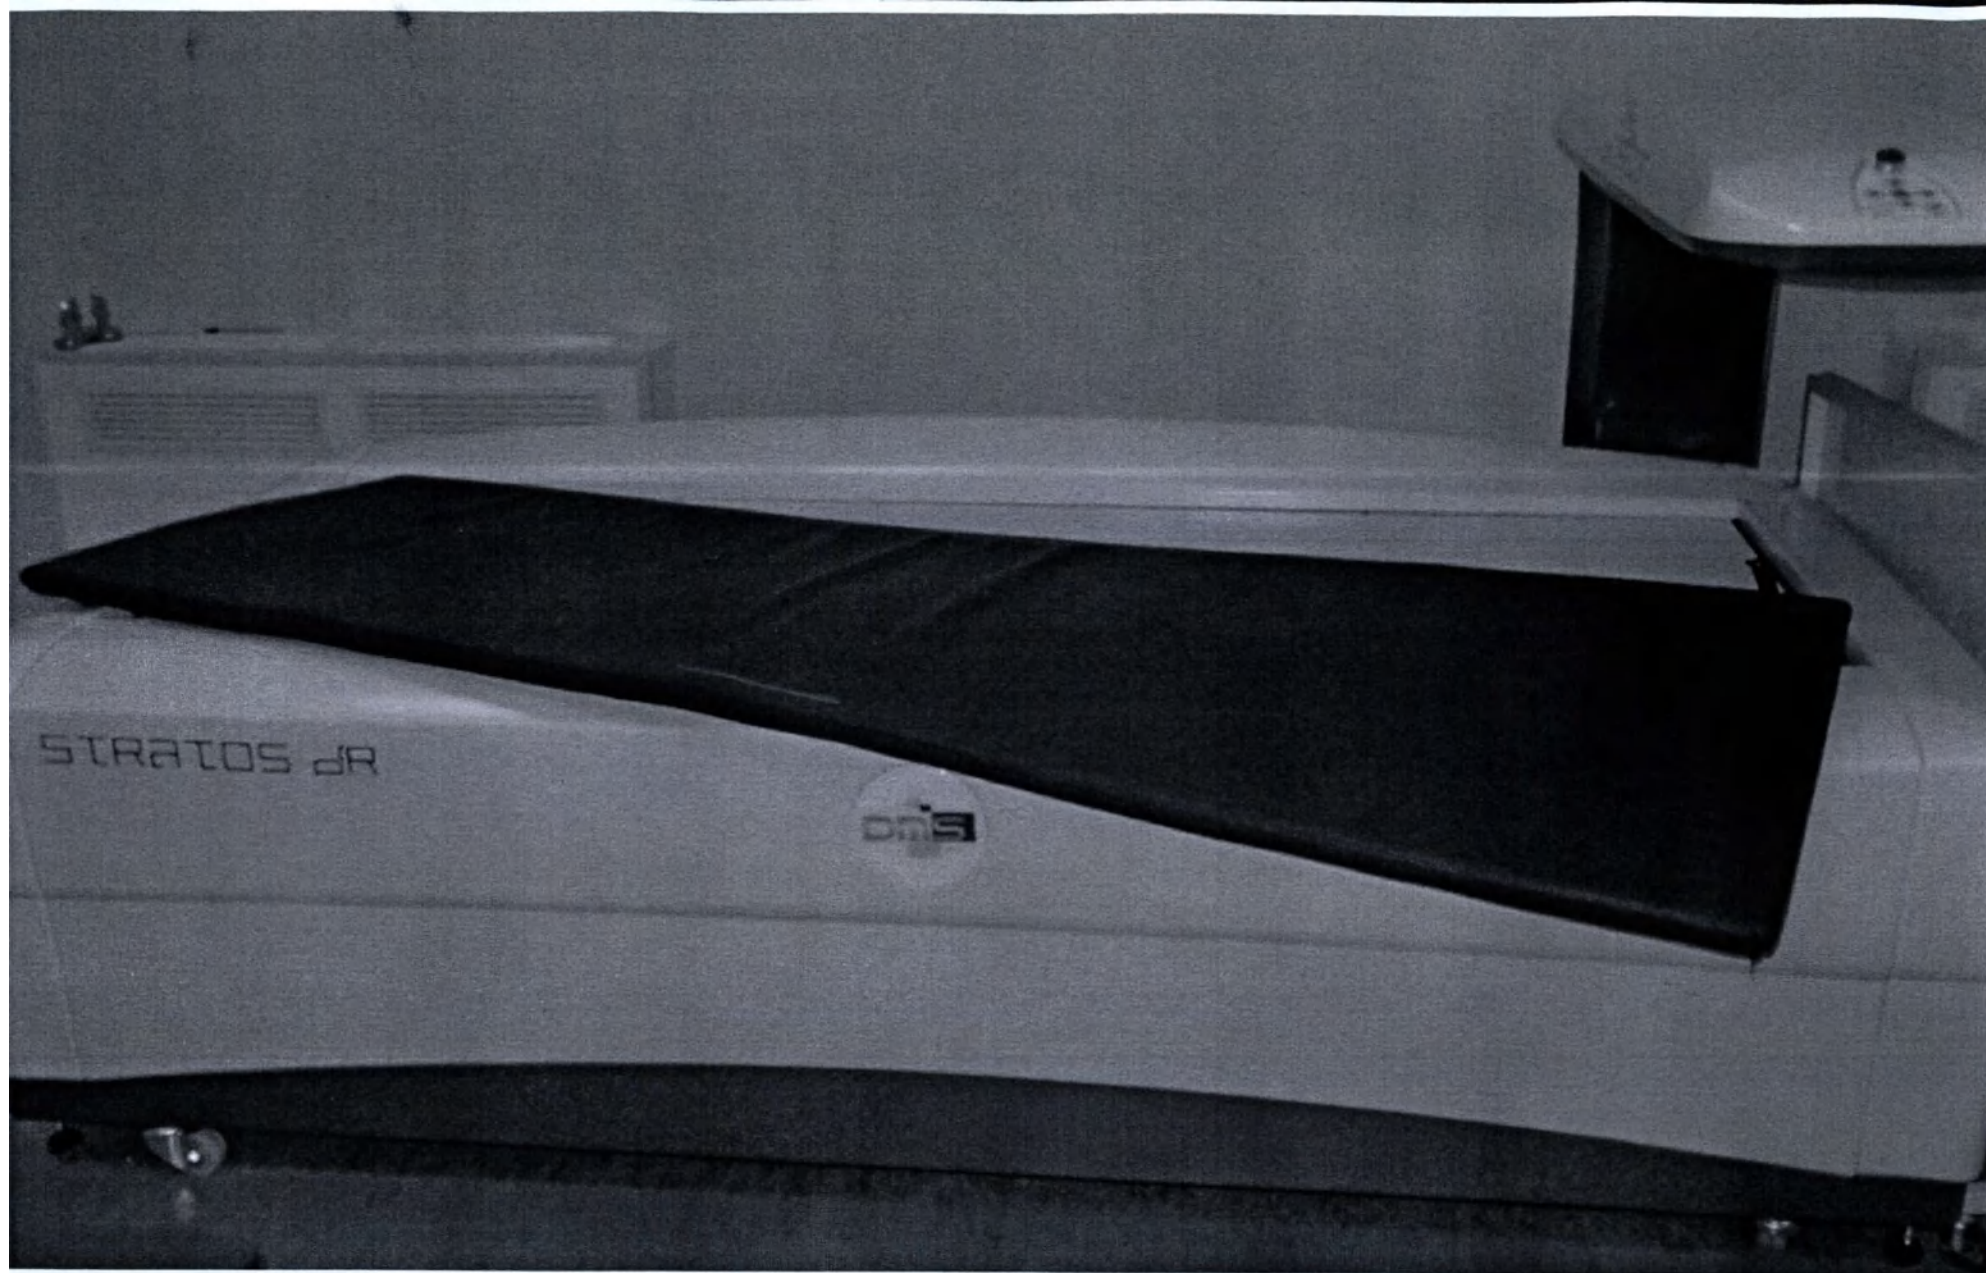


5. Матрас пациента

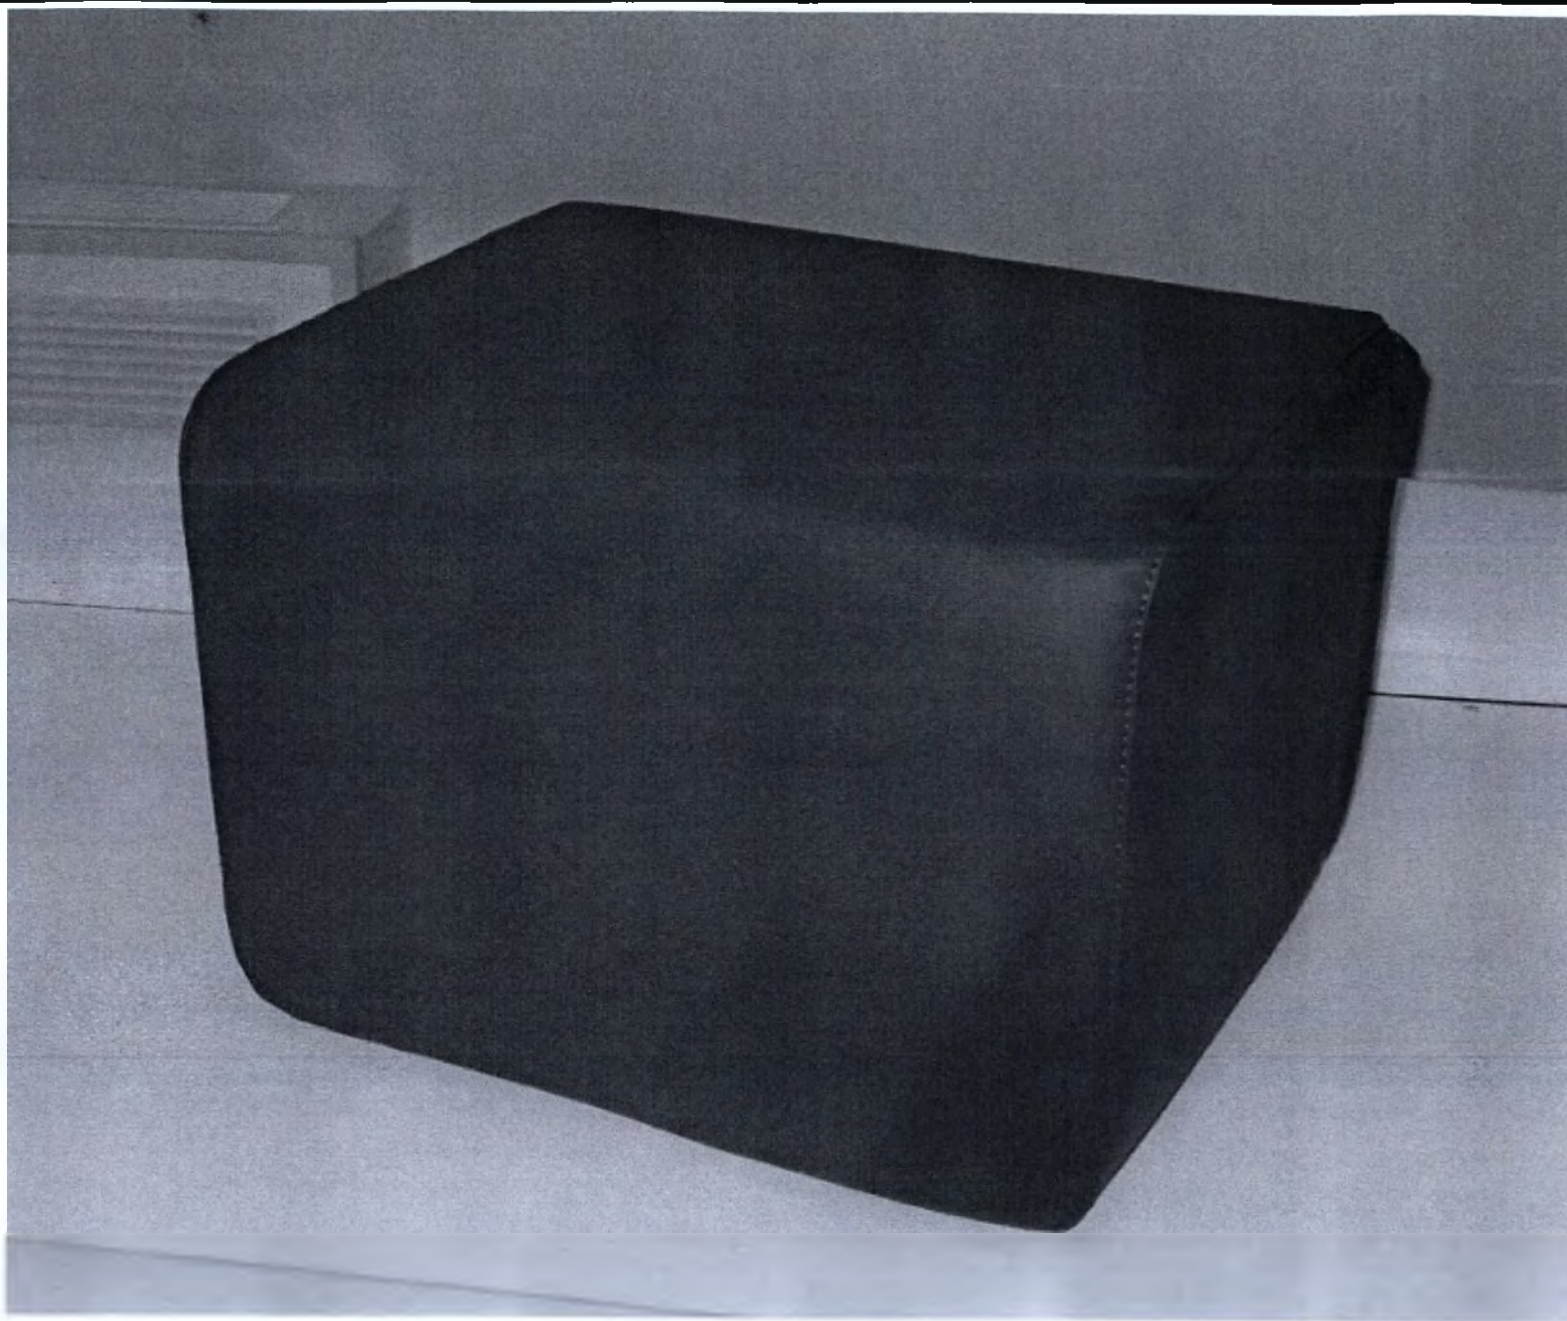

6. Подушка для позиционирования ног при сканировании спины

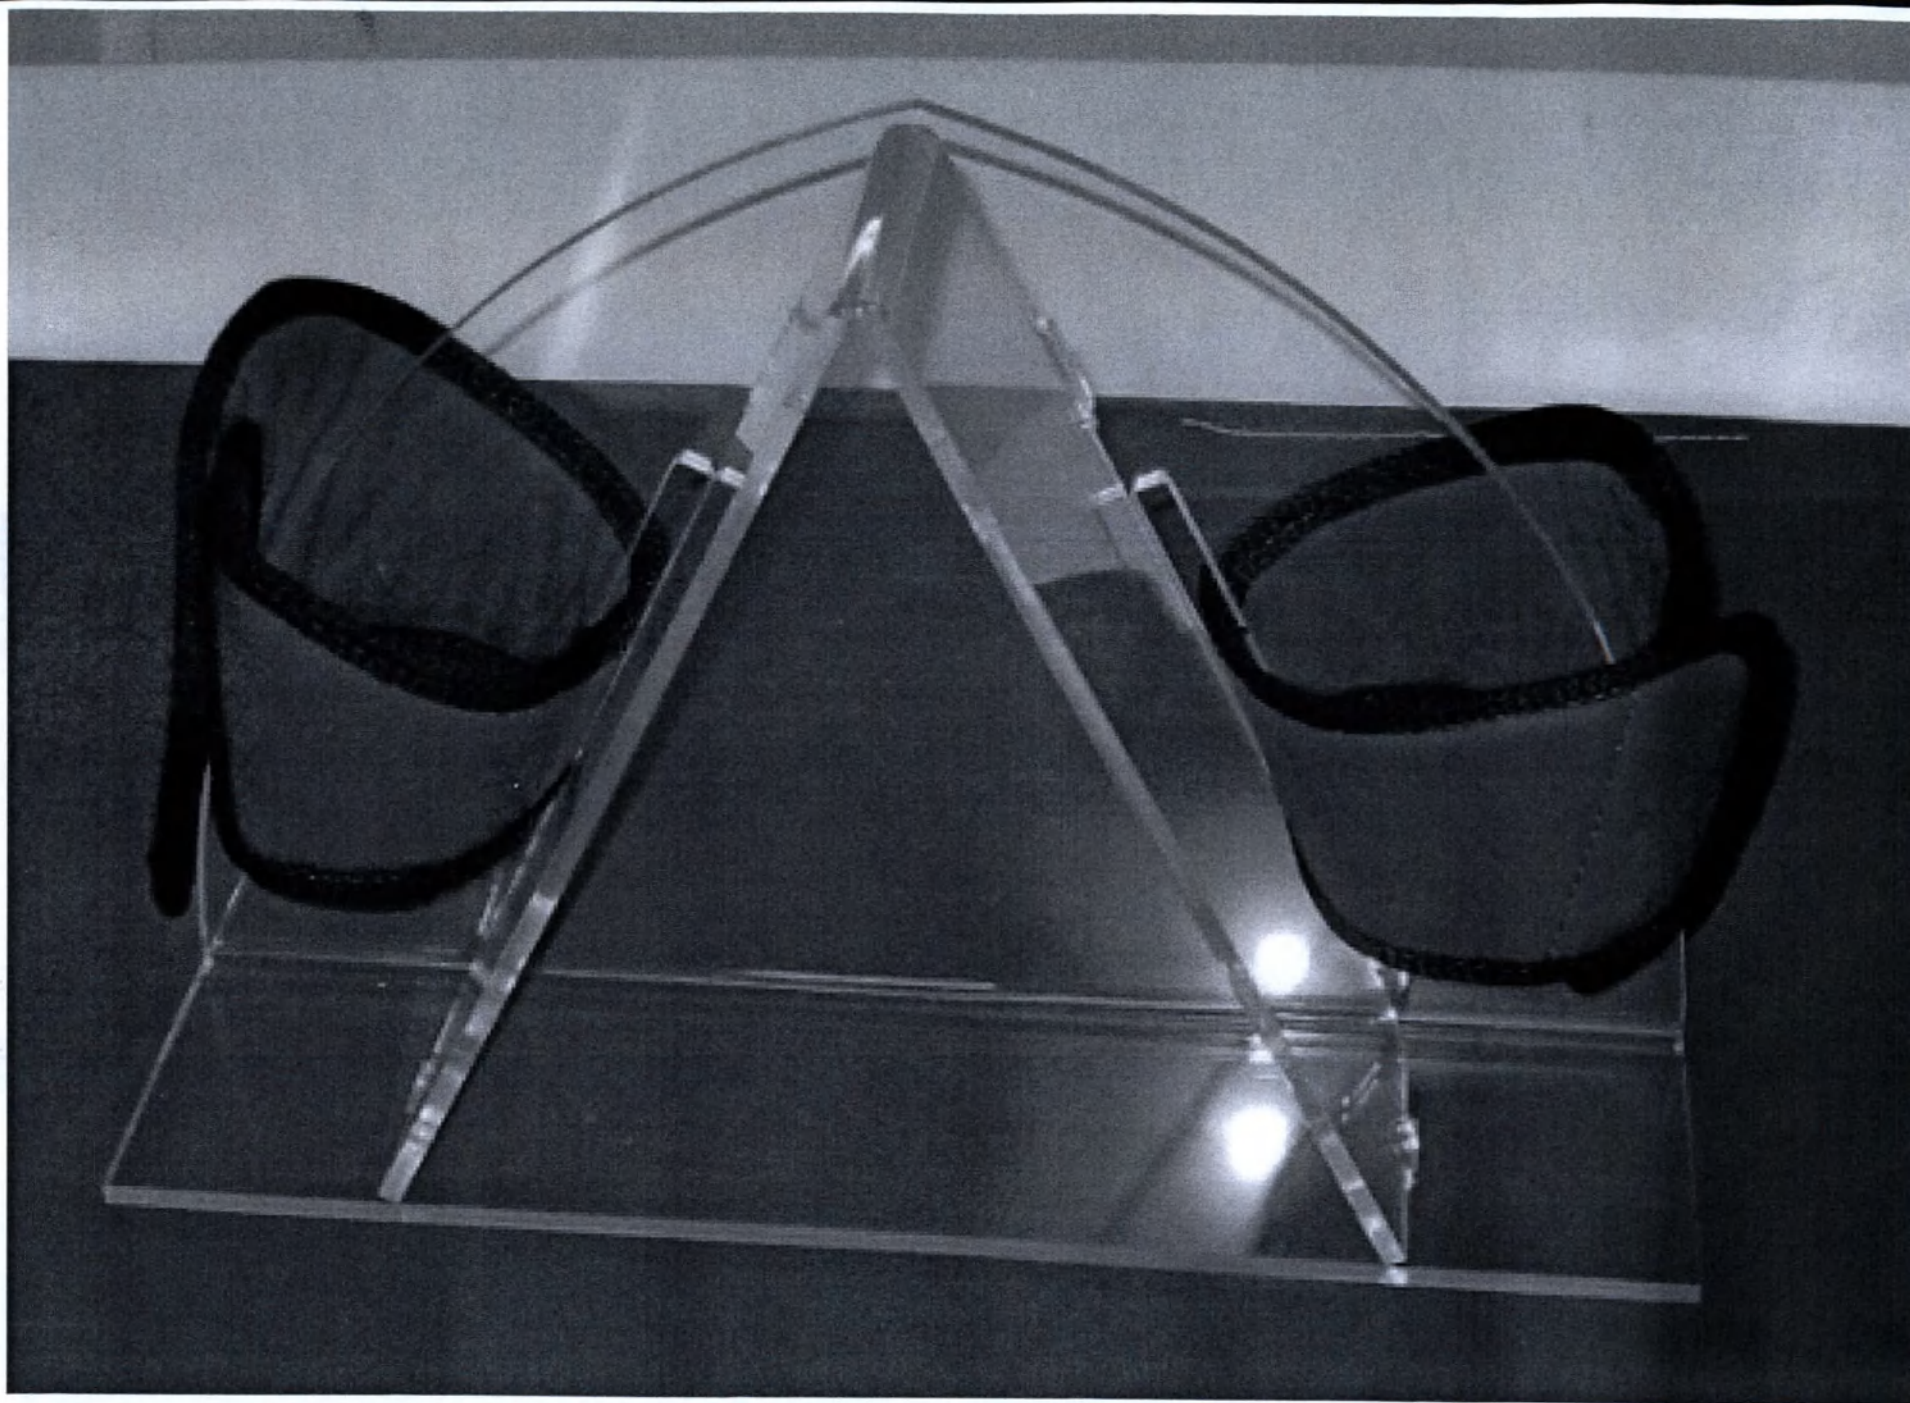

7. Фиксатор для ног при сканировании бедра

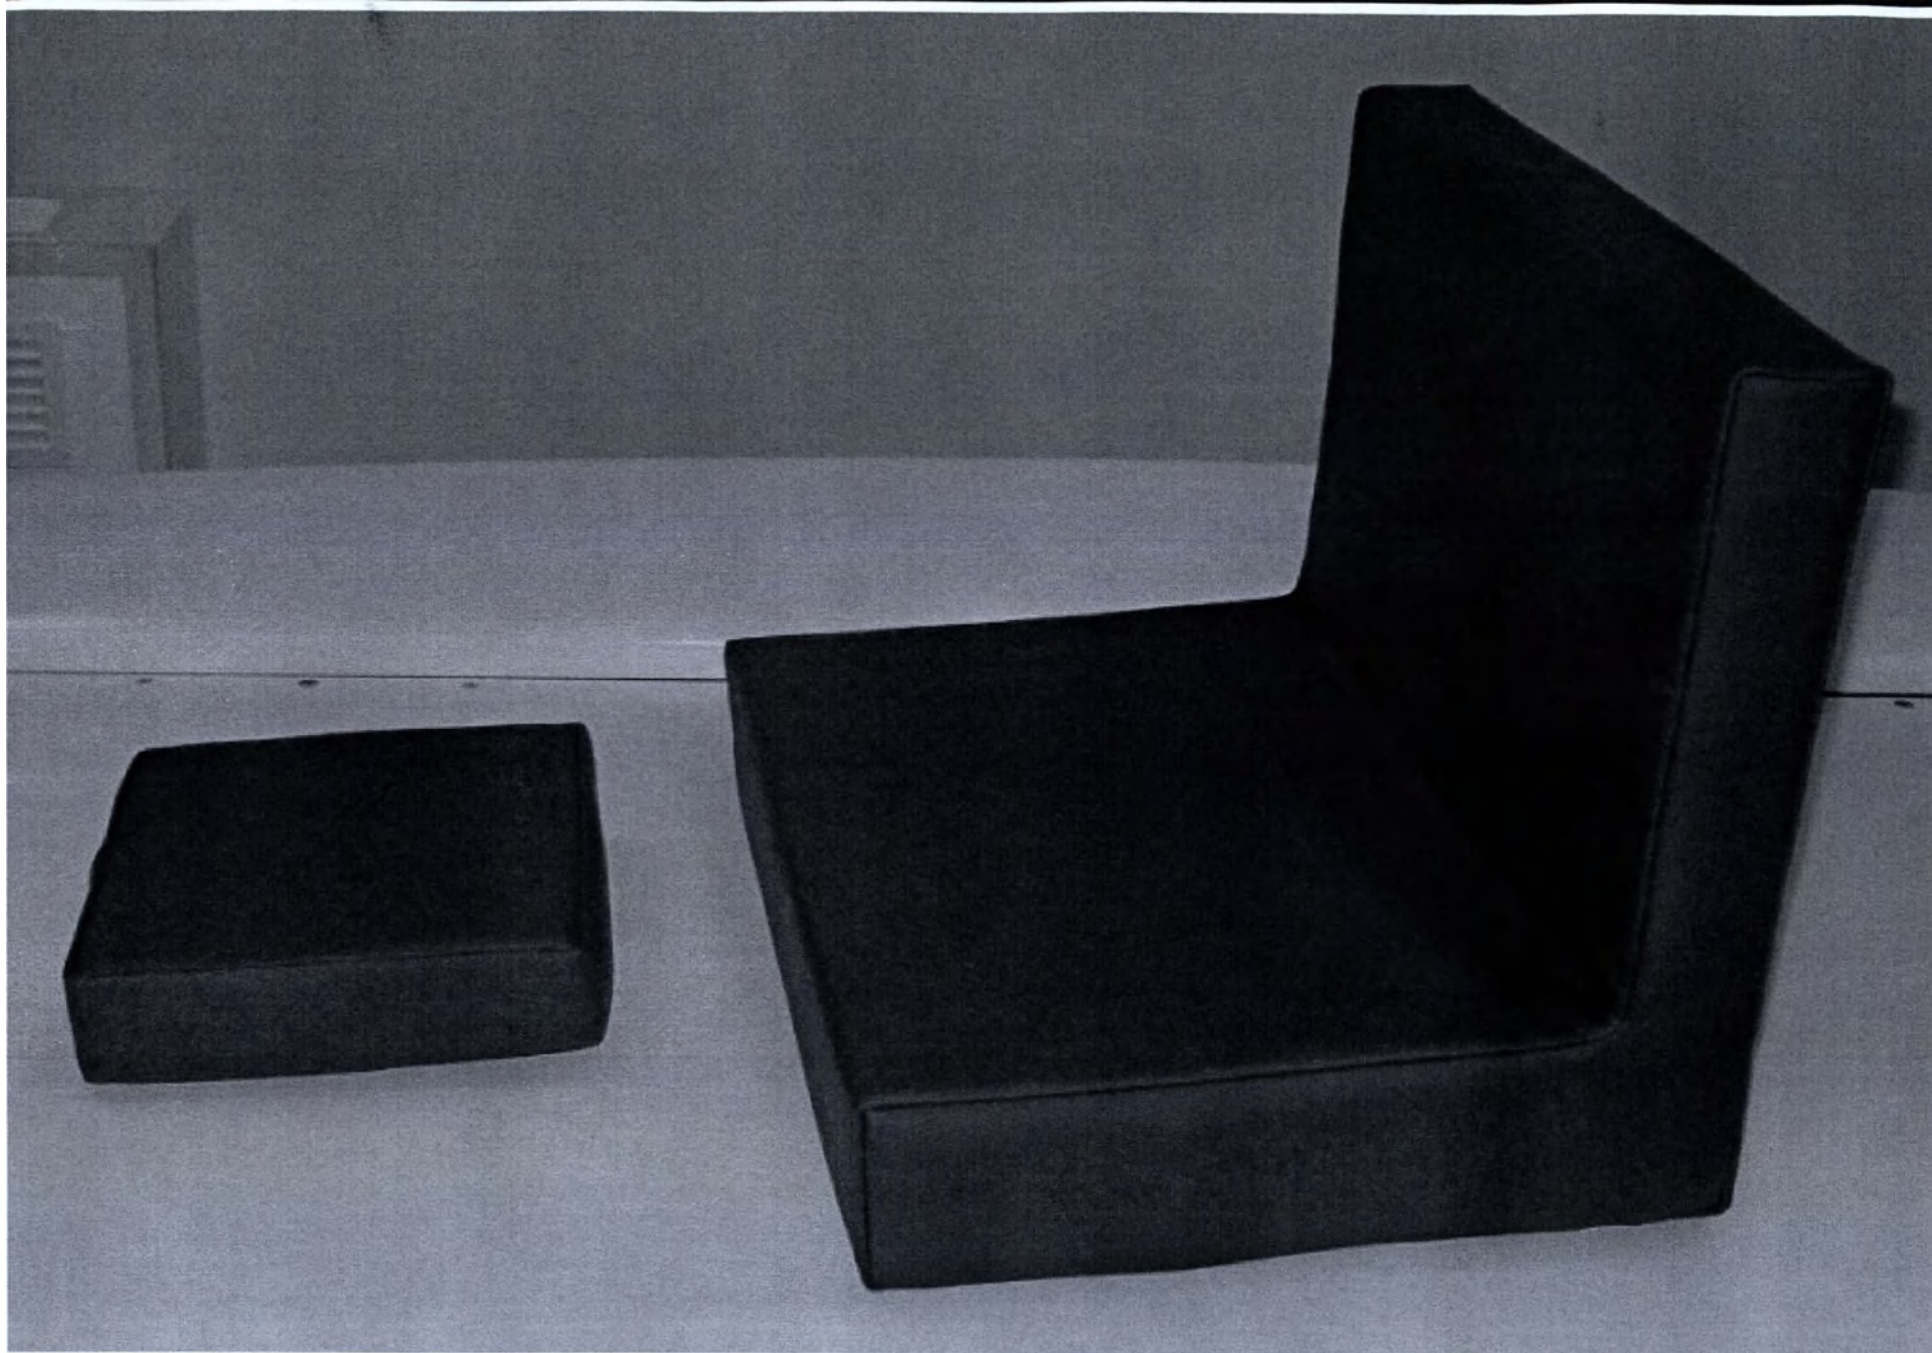

8. Комплект специальных подушек для сканирования на боку:
- подушка для позиционирования при цифровой оценке позвоночника (DVA) на боку; подушка для позиционирования при сканировании спины на боку (боковой BMD)



9. Программное обеспечение на CD-диске



10. Руководство пользователя на CD-диске

III. Остеоденситометр рентгеновский STRATOS dR с высокочастотным моноблоком 3 мА, в составе:




1. Остеоденситометр рентгеновский STRATOS dR




2. Кабель питания




3. Сетевой кабель LAN (5м, кат.5Е)

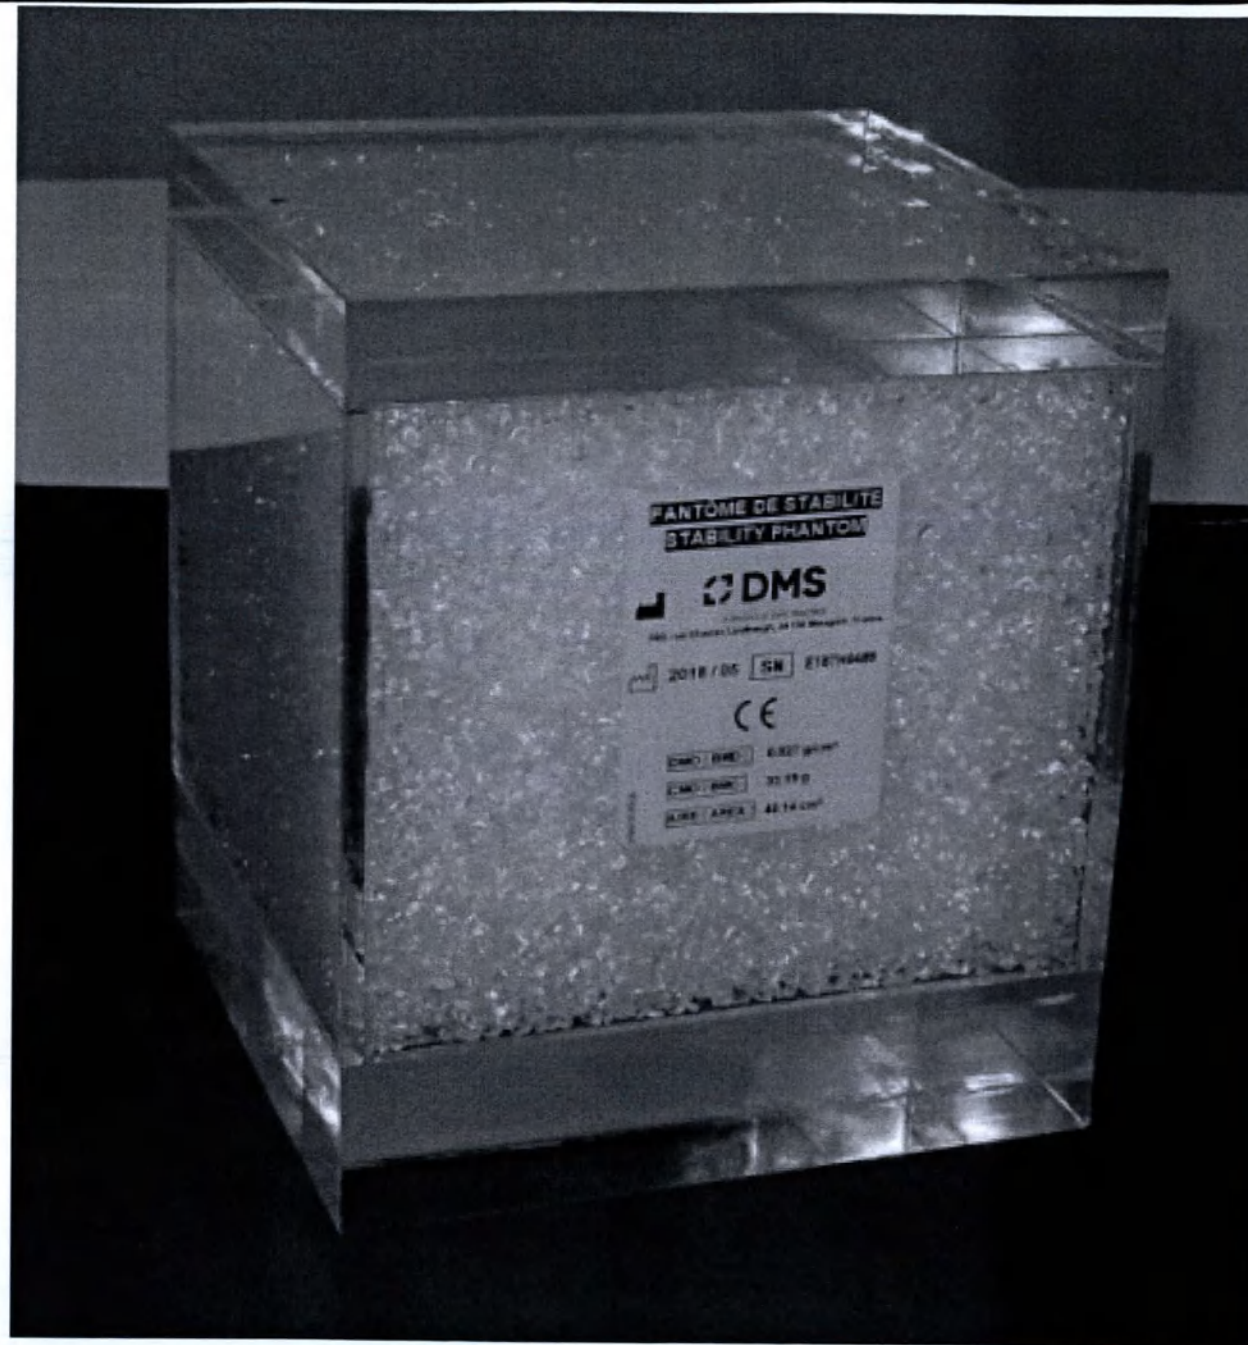


4. Фантом спины (ЗРОІ) для калибровки

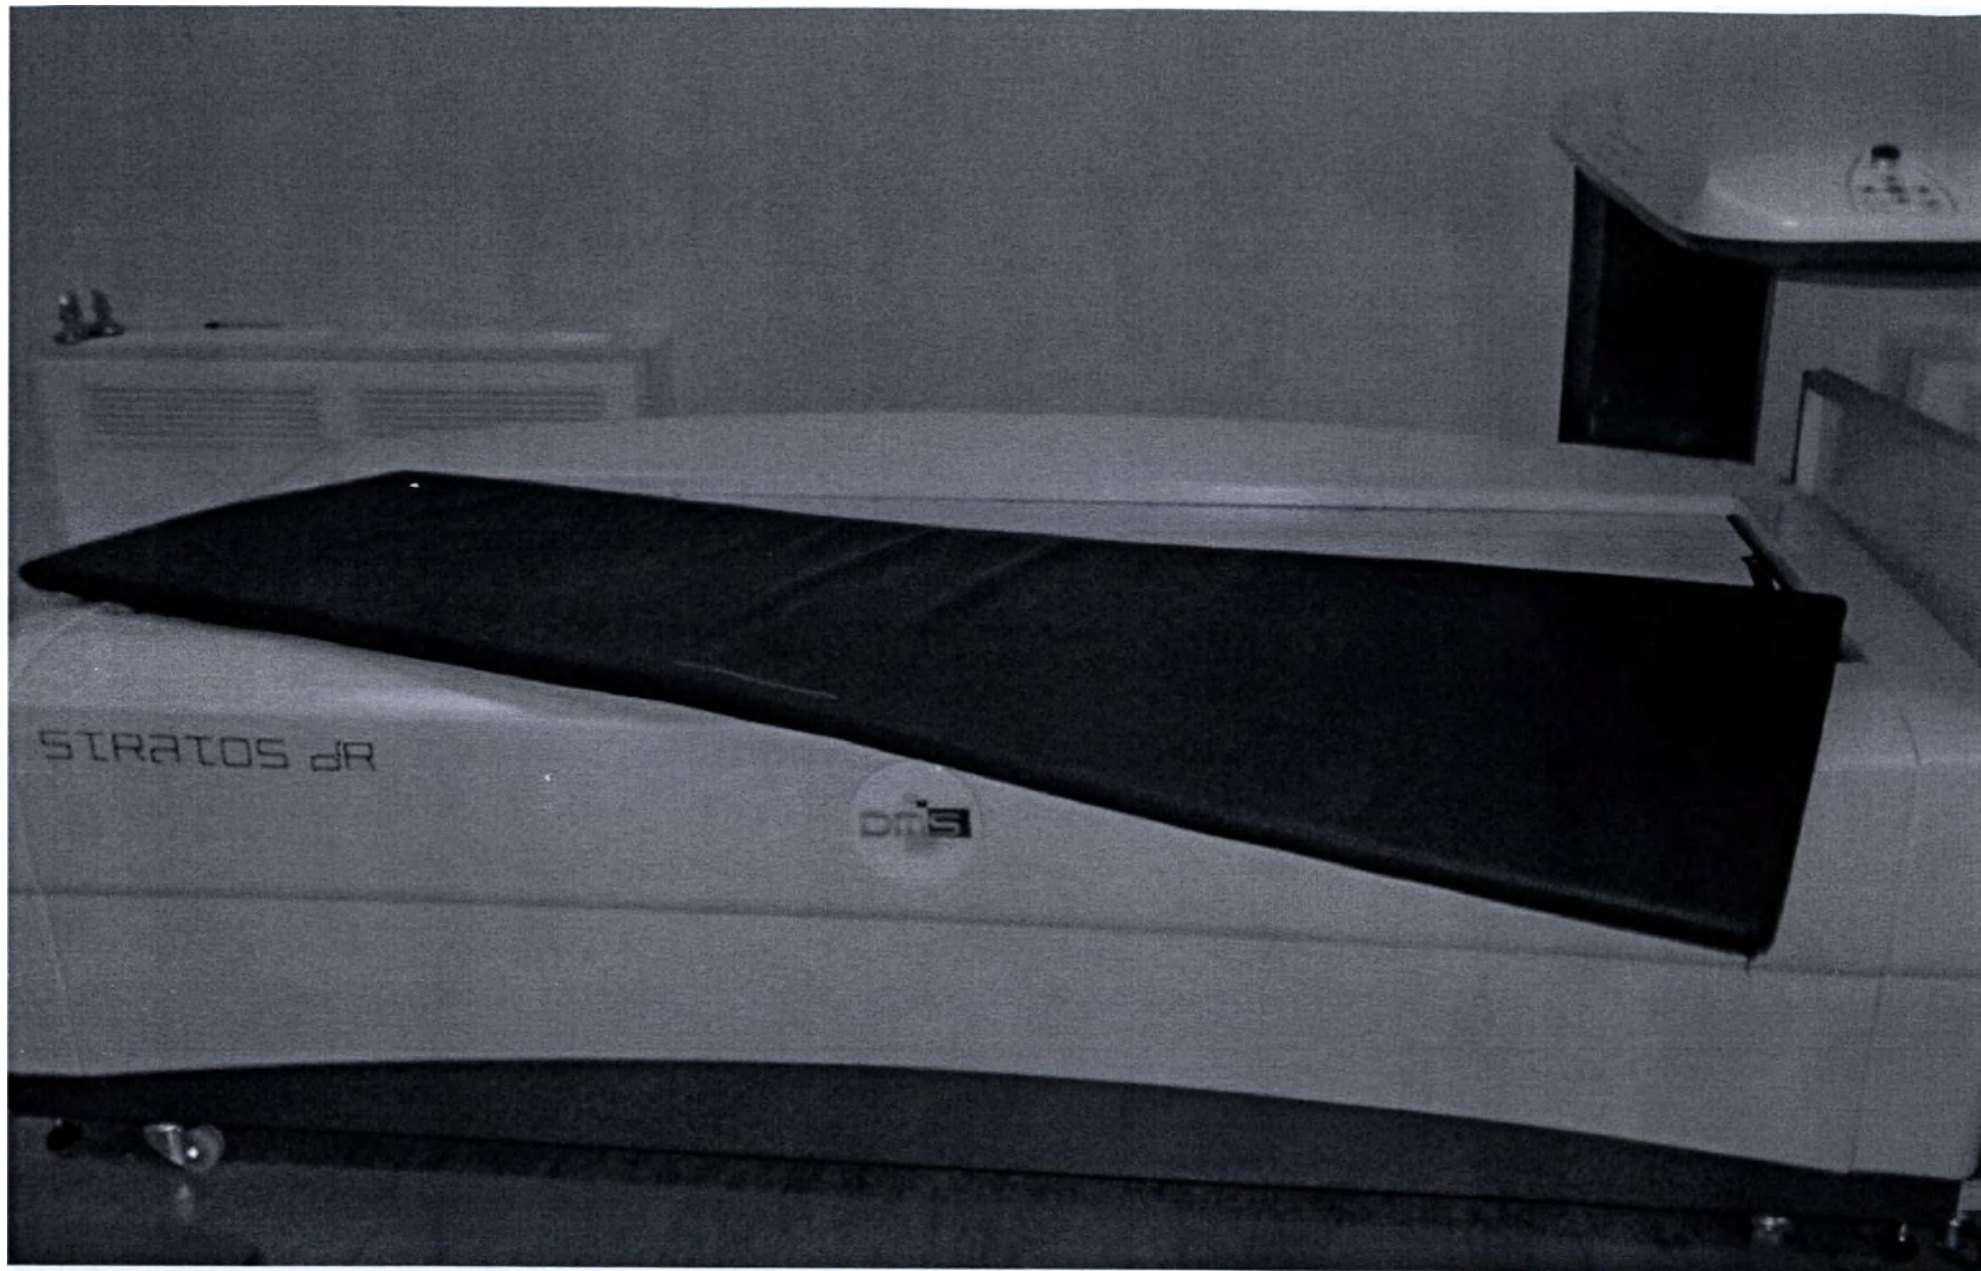


5. Матрас пациента

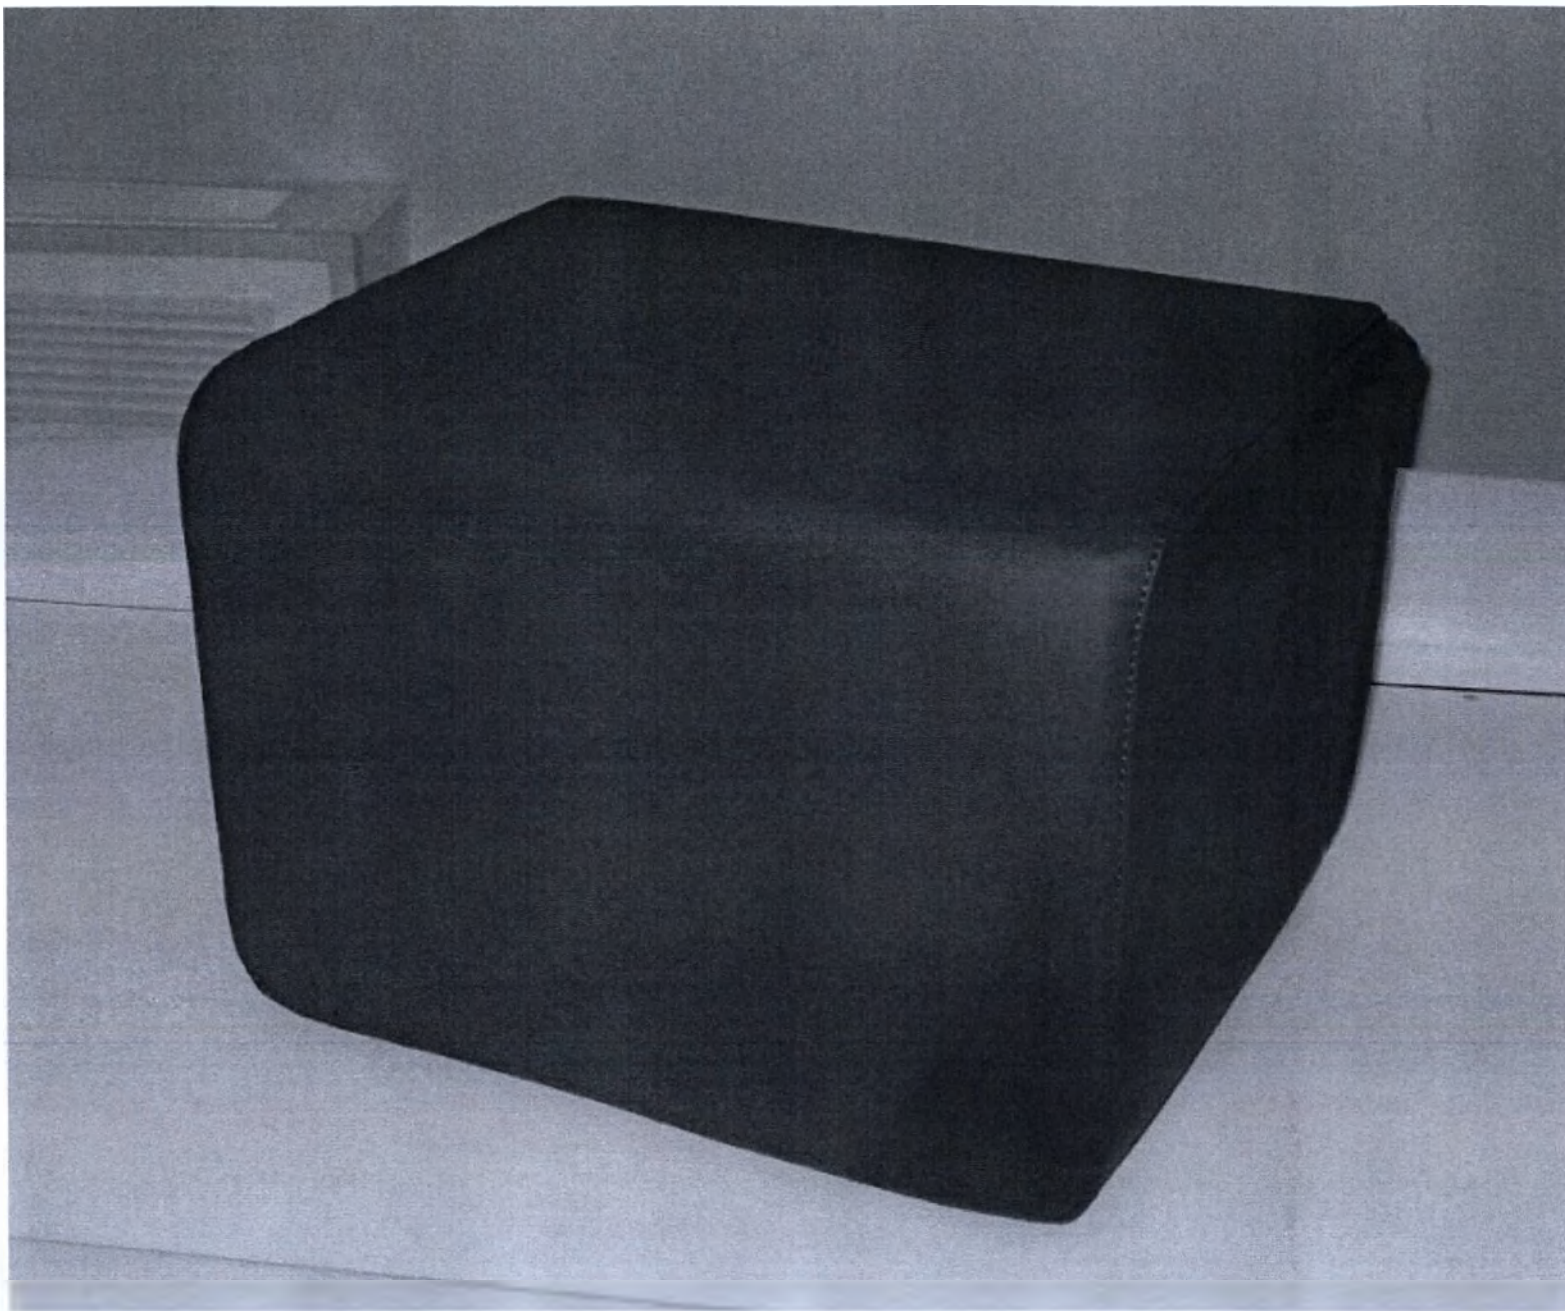

6. Подушка для позиционирования ног при сканировании спины

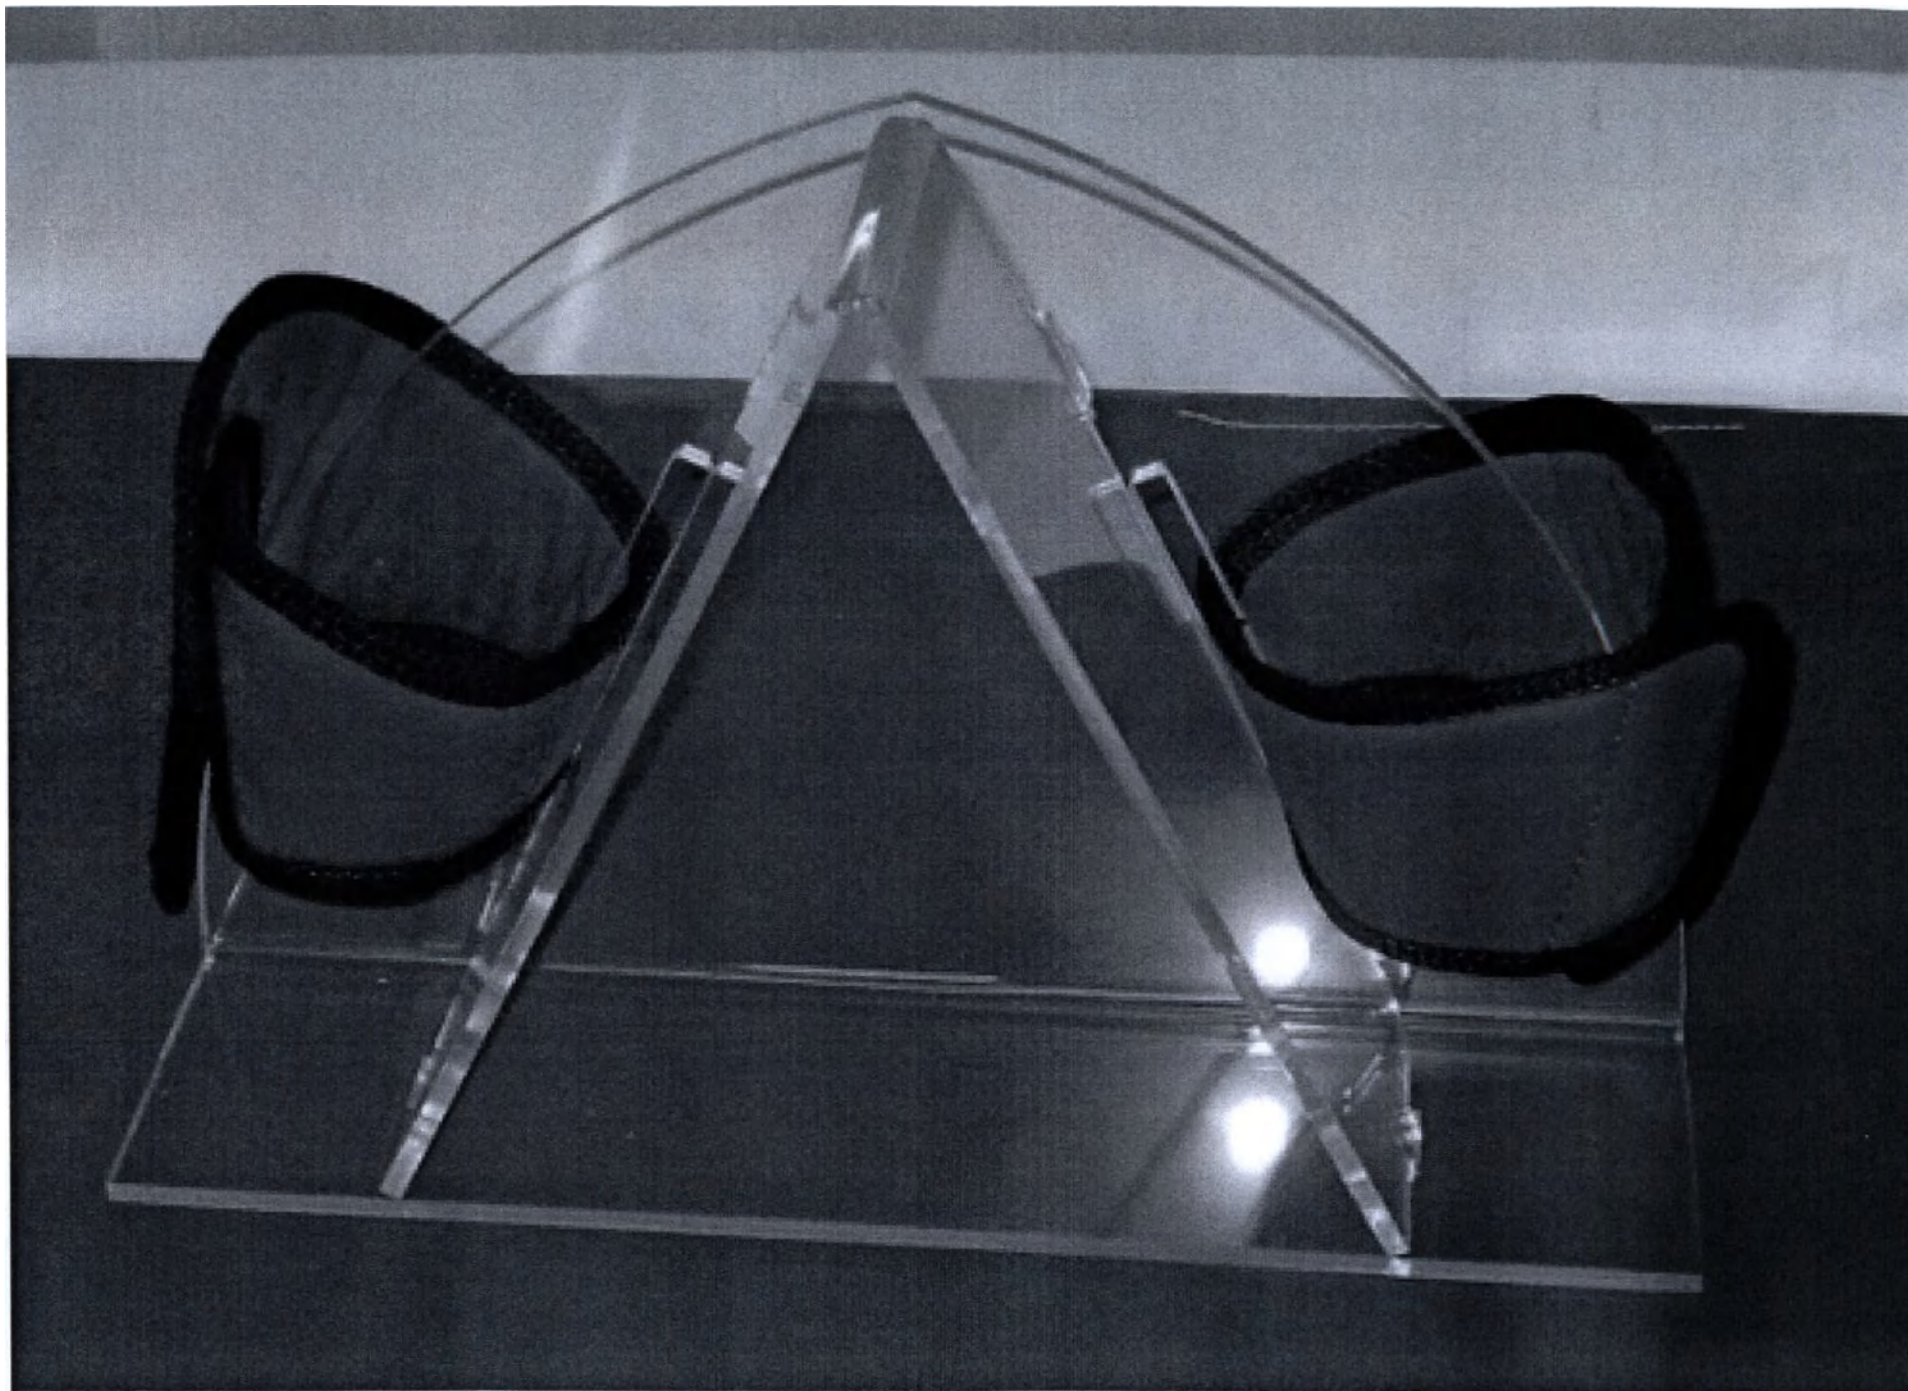

7. Фиксатор для ног при сканировании бедра

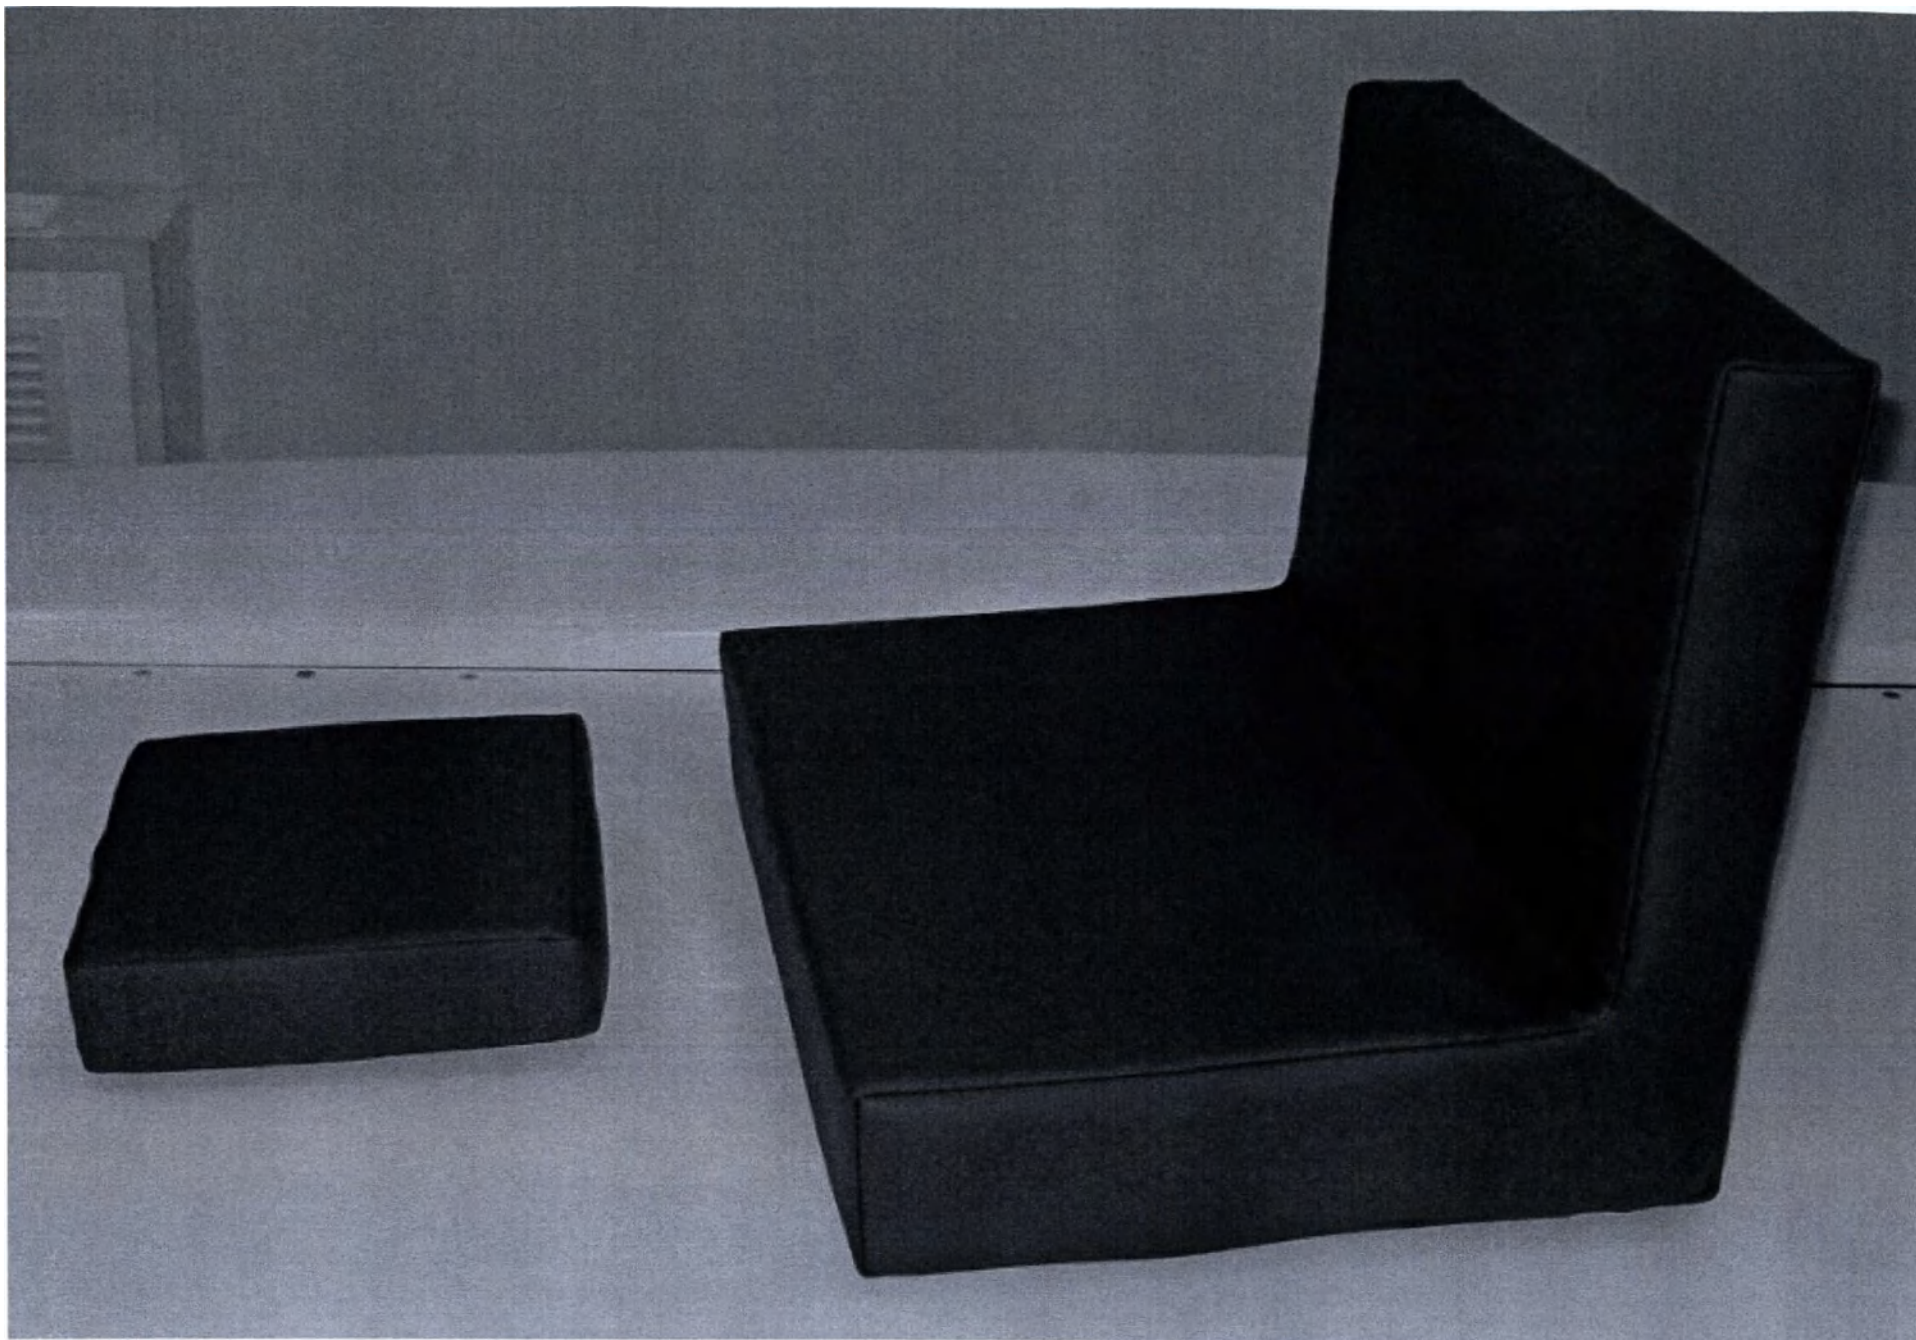

8. Комплект специальных подушек для сканирования на боку:
- подушка для позиционирования при цифровой оценке позвоночника (DVA) на боку; подушка для позиционирования при сканировании спины на боку (боковой BMD)



9. Программное обеспечение на CD-диске




10. Руководство пользователя на CD-диске


IV. Остеоденситометр рентгеновский STRATOS dR с высокочастотным моноблоком 3,2 мА, в составе:



1. Остеоденситометр рентгеновский STRATOS dR

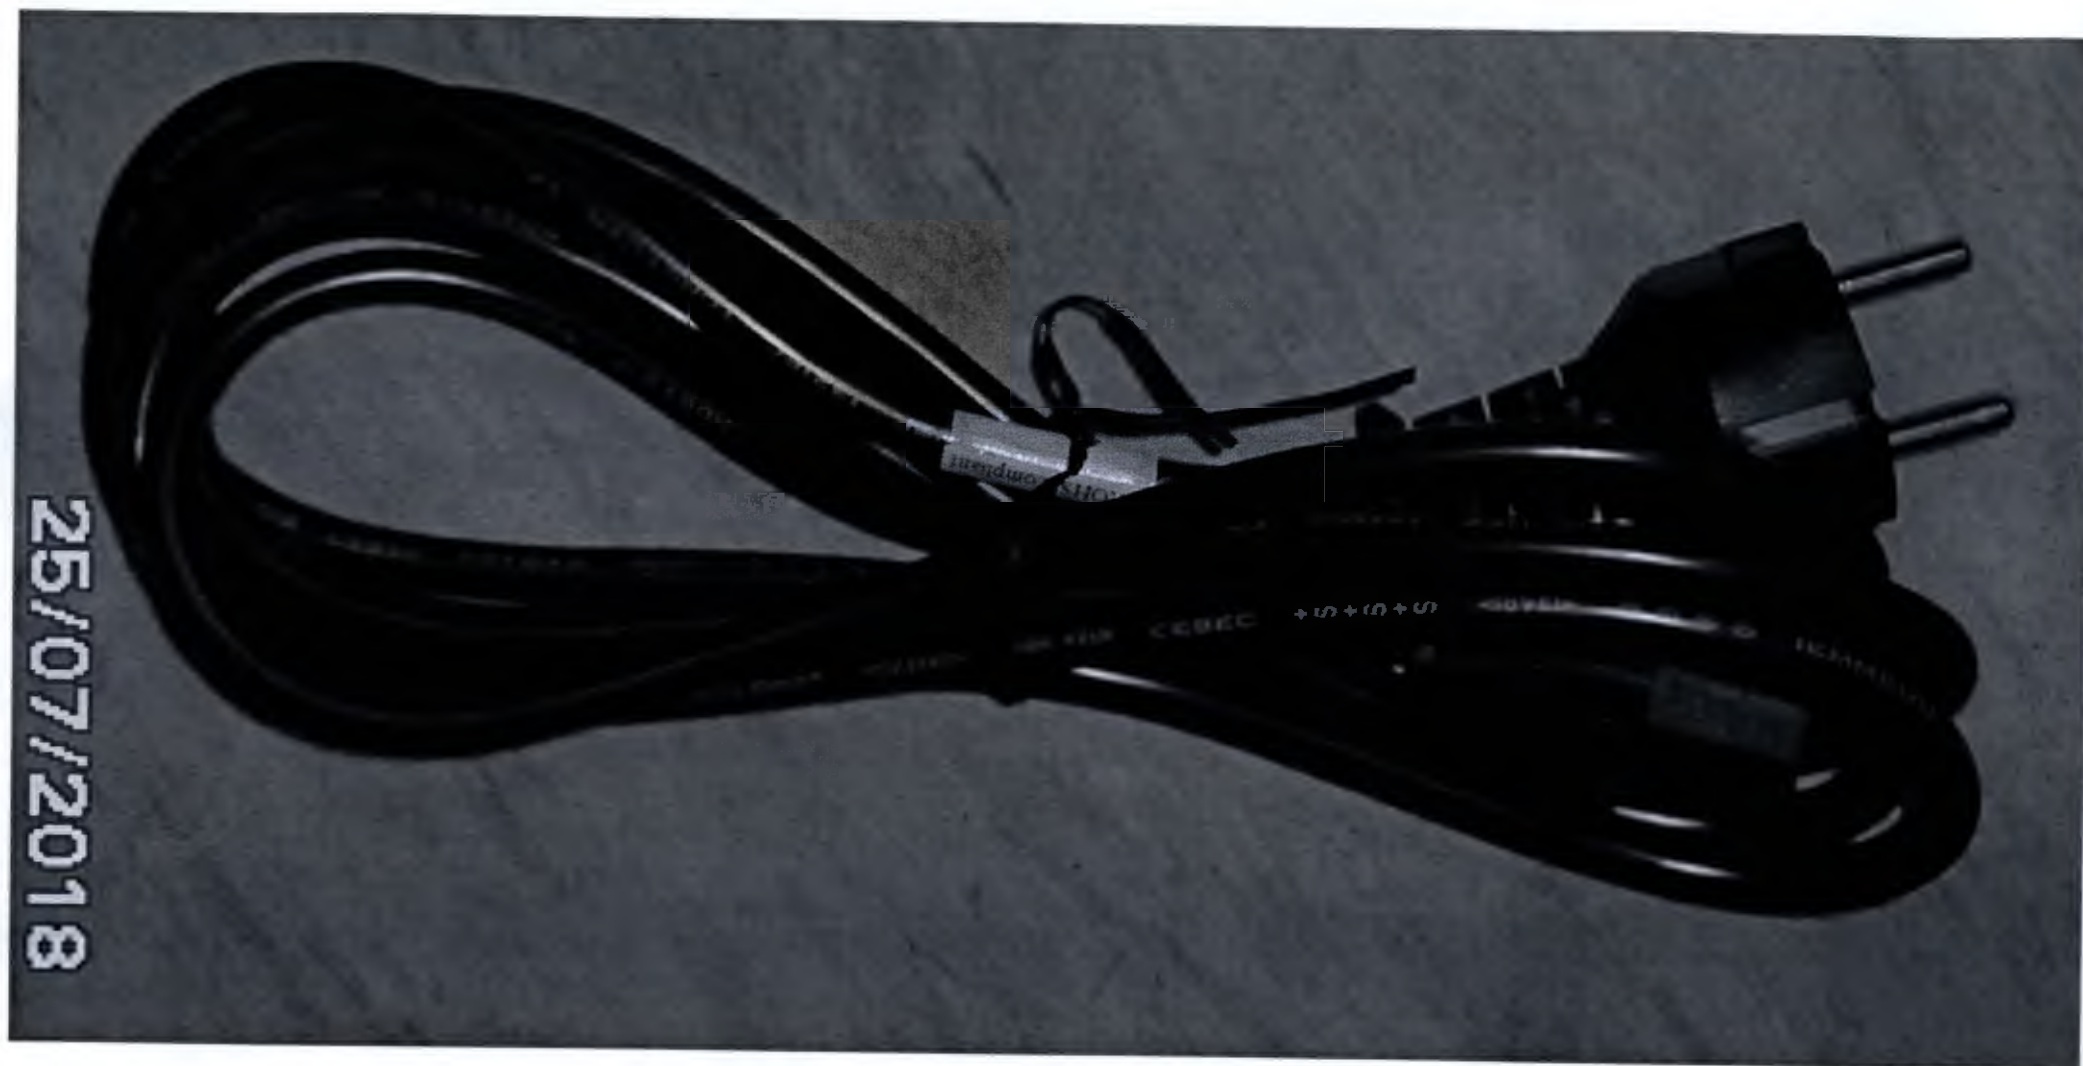


2. Кабель питания

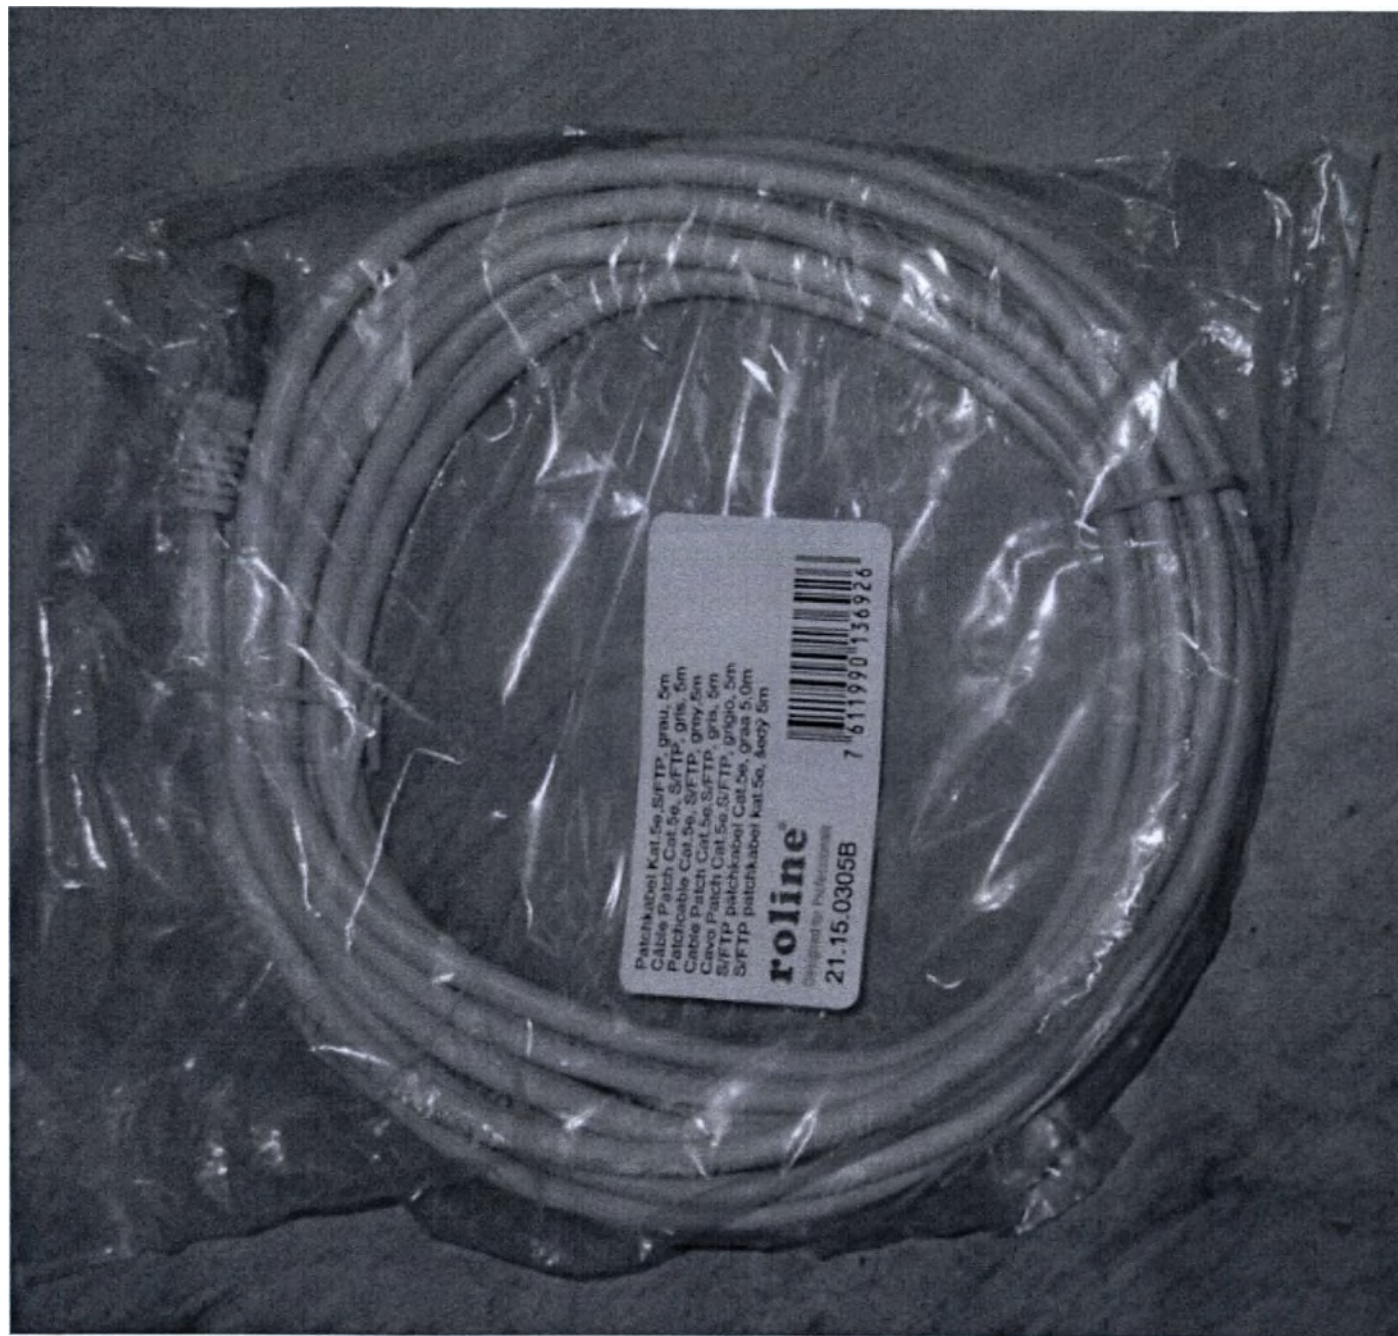


3. Сетевой кабель LAN (5м, кат.5Е)




4. Фантом спины (3ROI) для калибровки

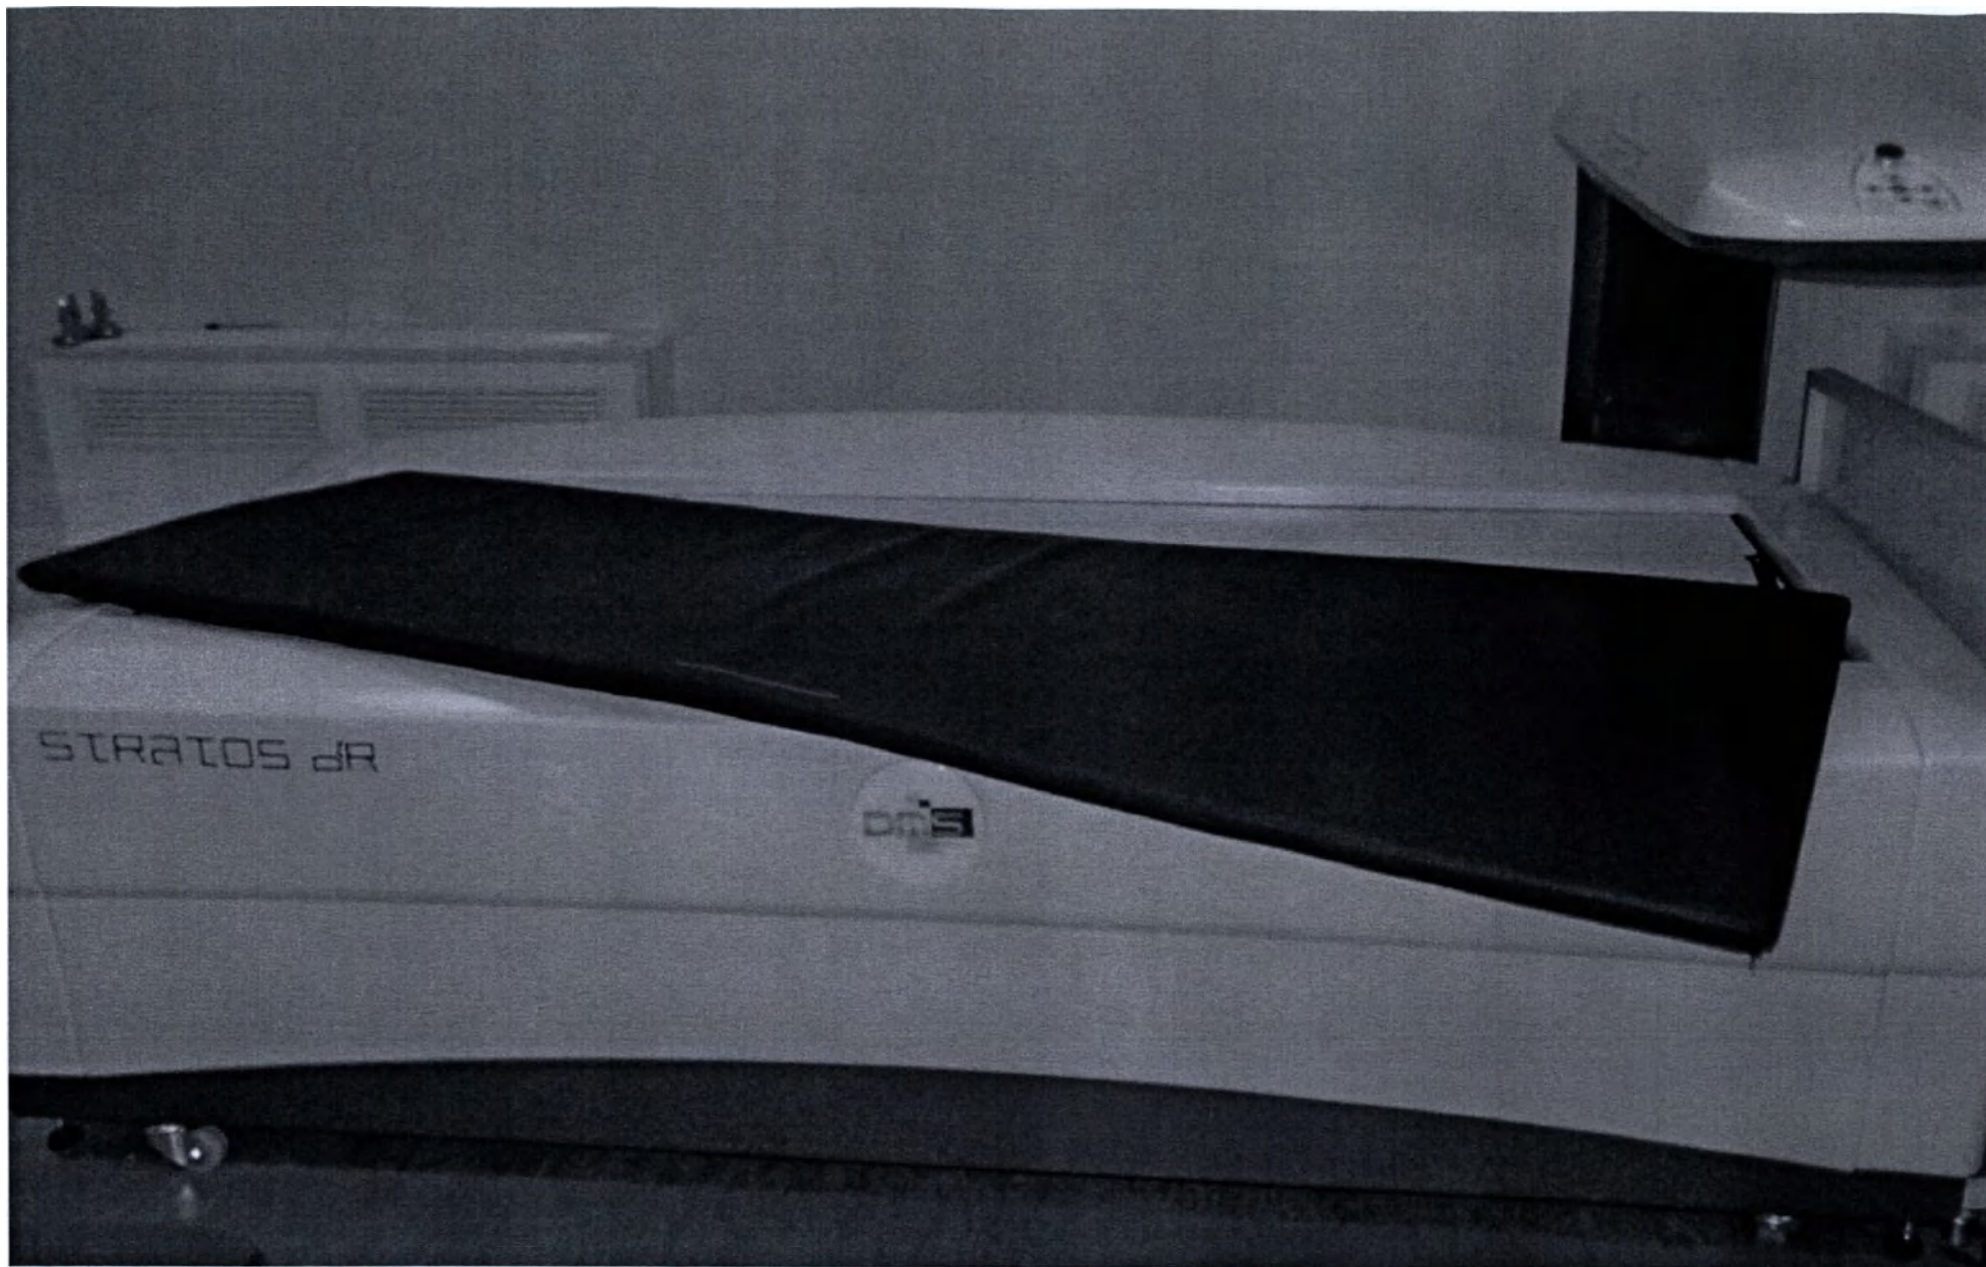


5. Матрас пациента

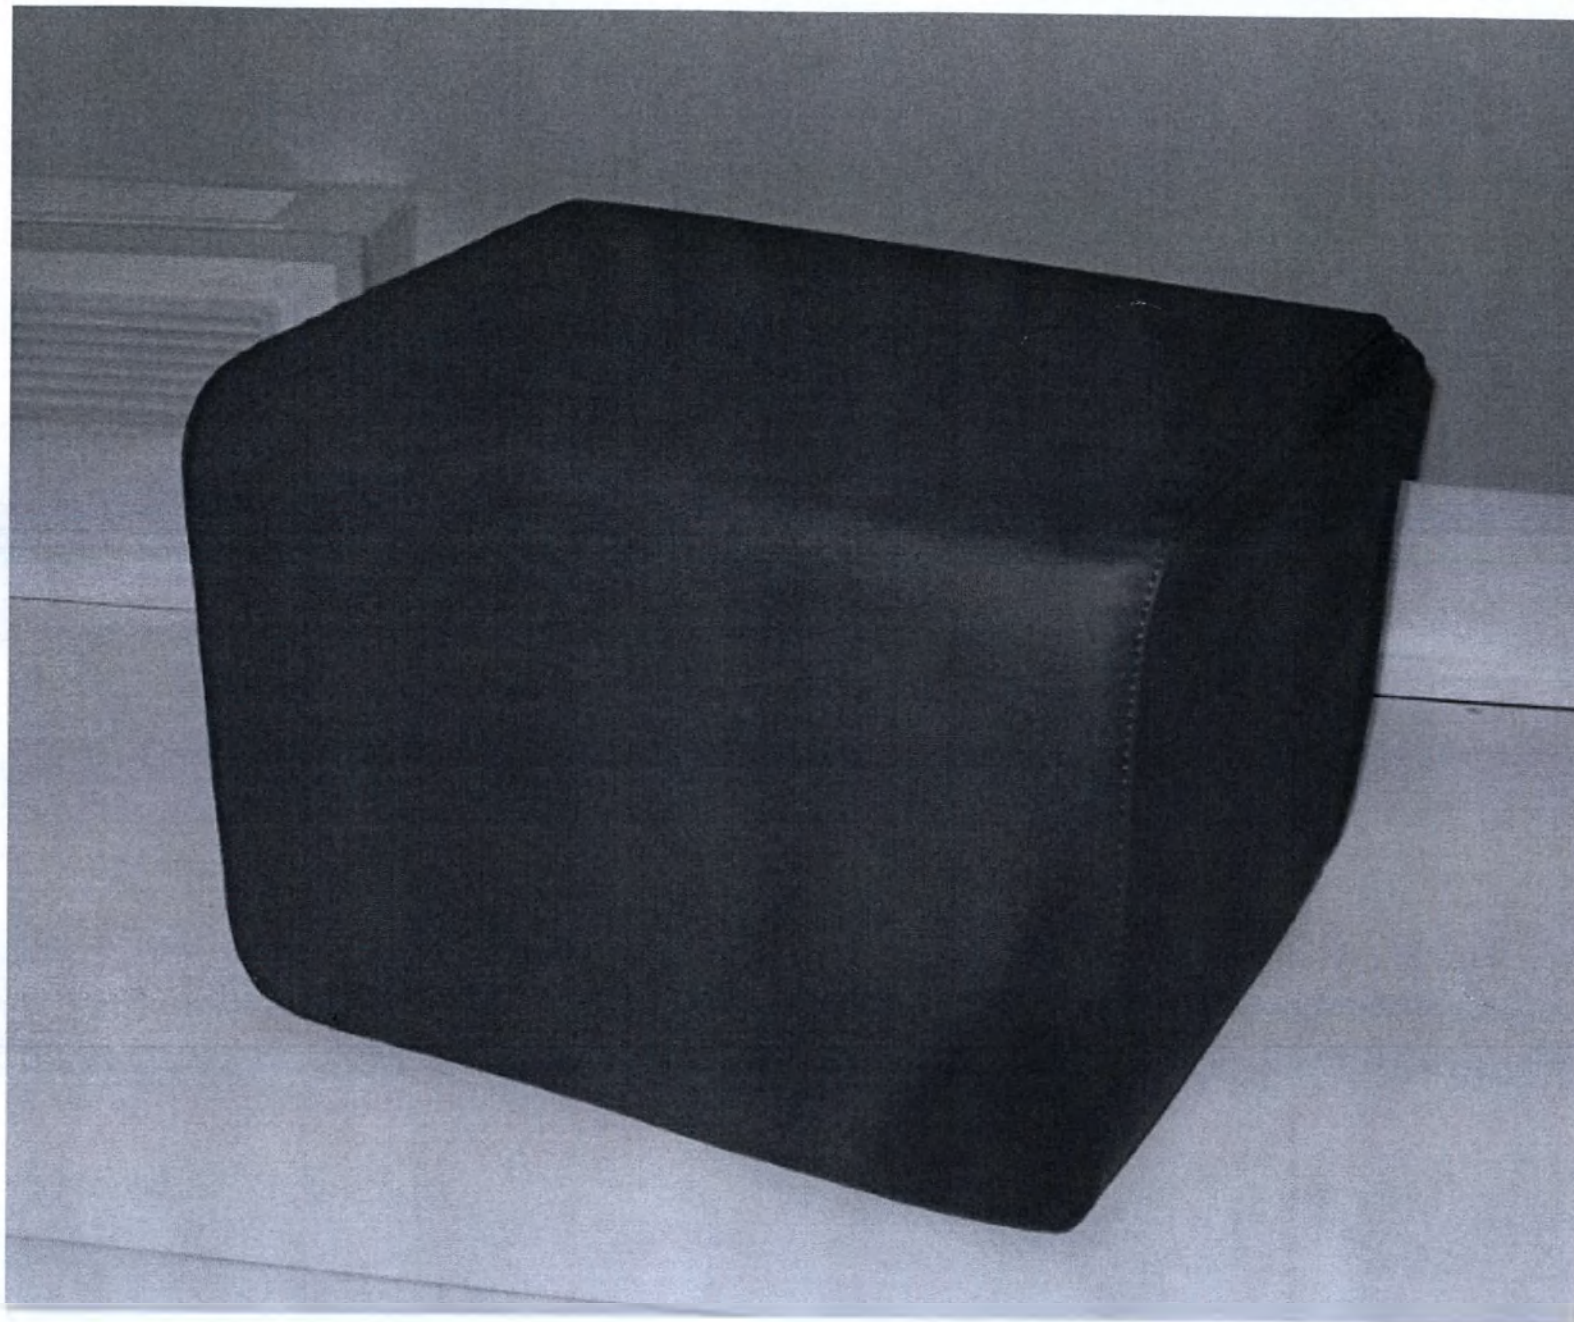

6. Подушка для позиционирования ног при сканировании спины

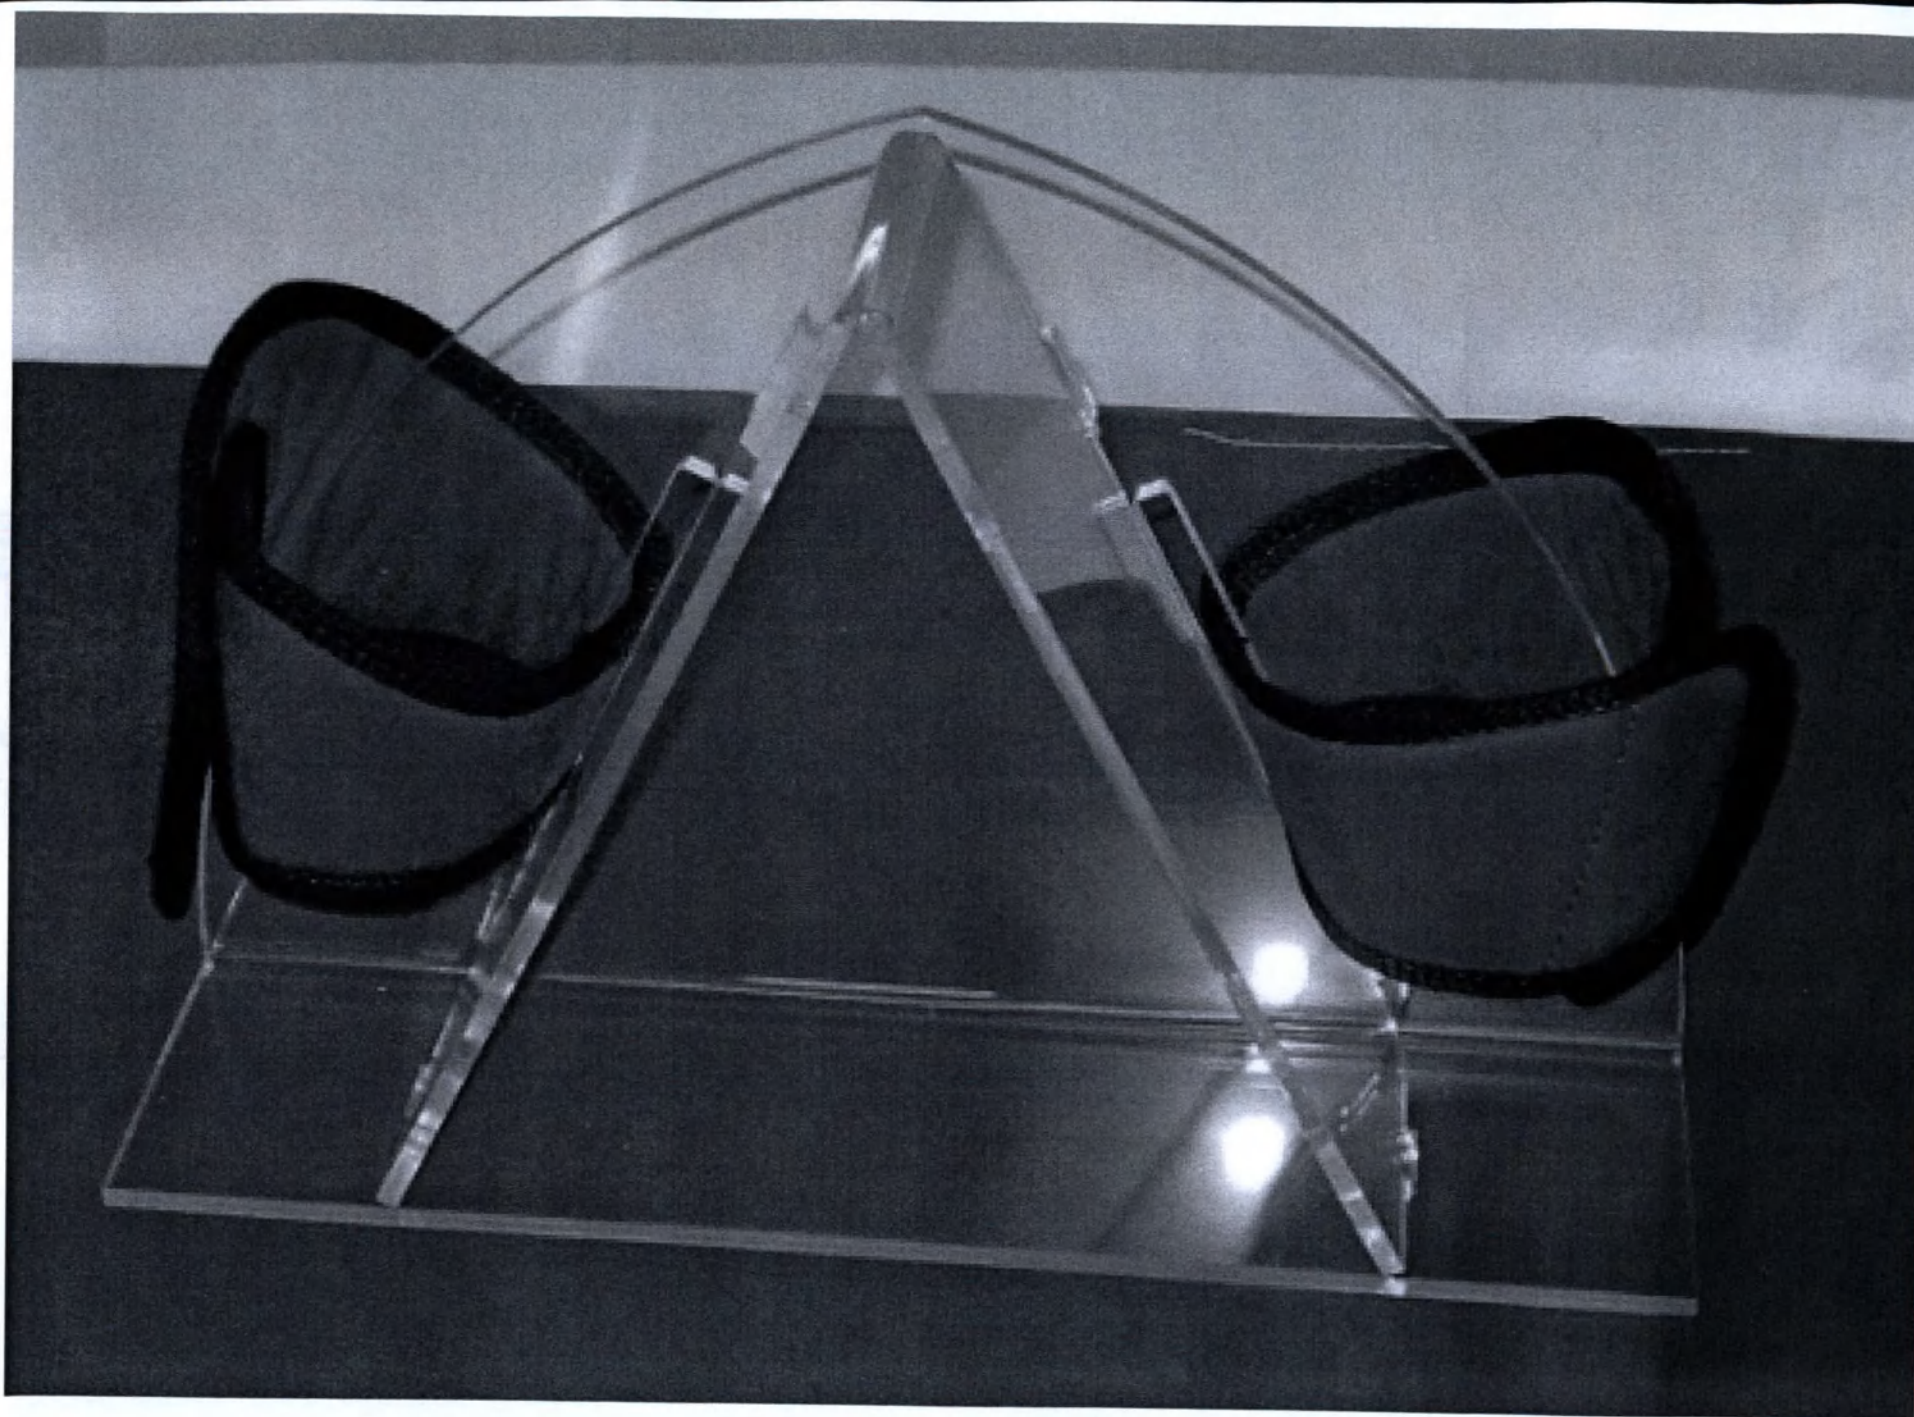

7. Фиксатор для ног при сканировании бедра

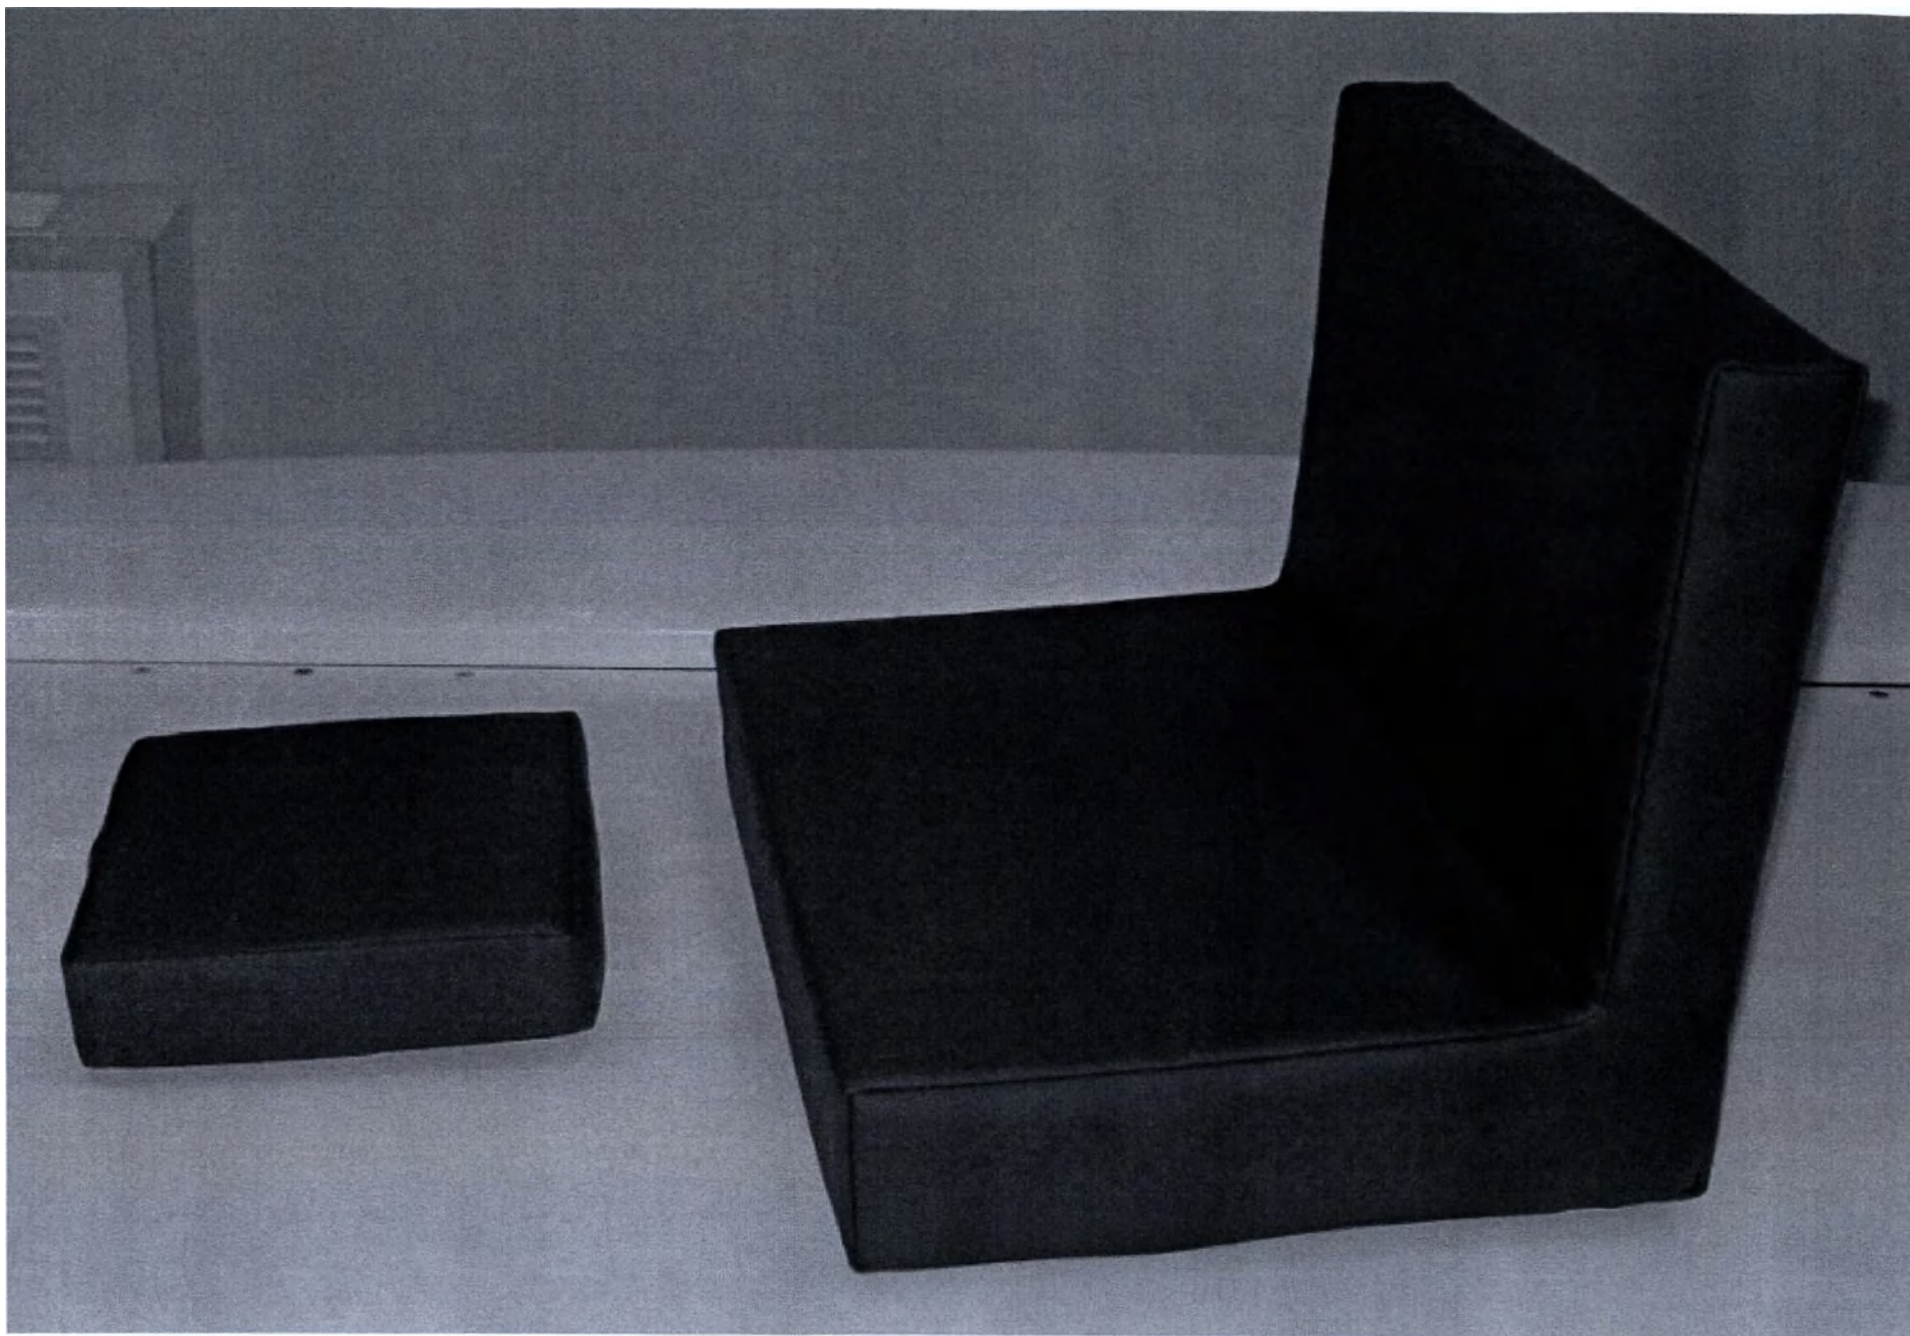

8. Комплект специальных подушек для сканирования на боку:

- подушка для позиционирования при цифровой оценке позвоночника (DVA) на боку; подушка для позиционирования при сканировании спины на боку (боковой BMD)




9. Программное обеспечение на CD-диске



10. Руководство пользователя на CD-диске

V. Принадлежности:

Модуль 3D-DXA реконструкции бедренной кости в составе:

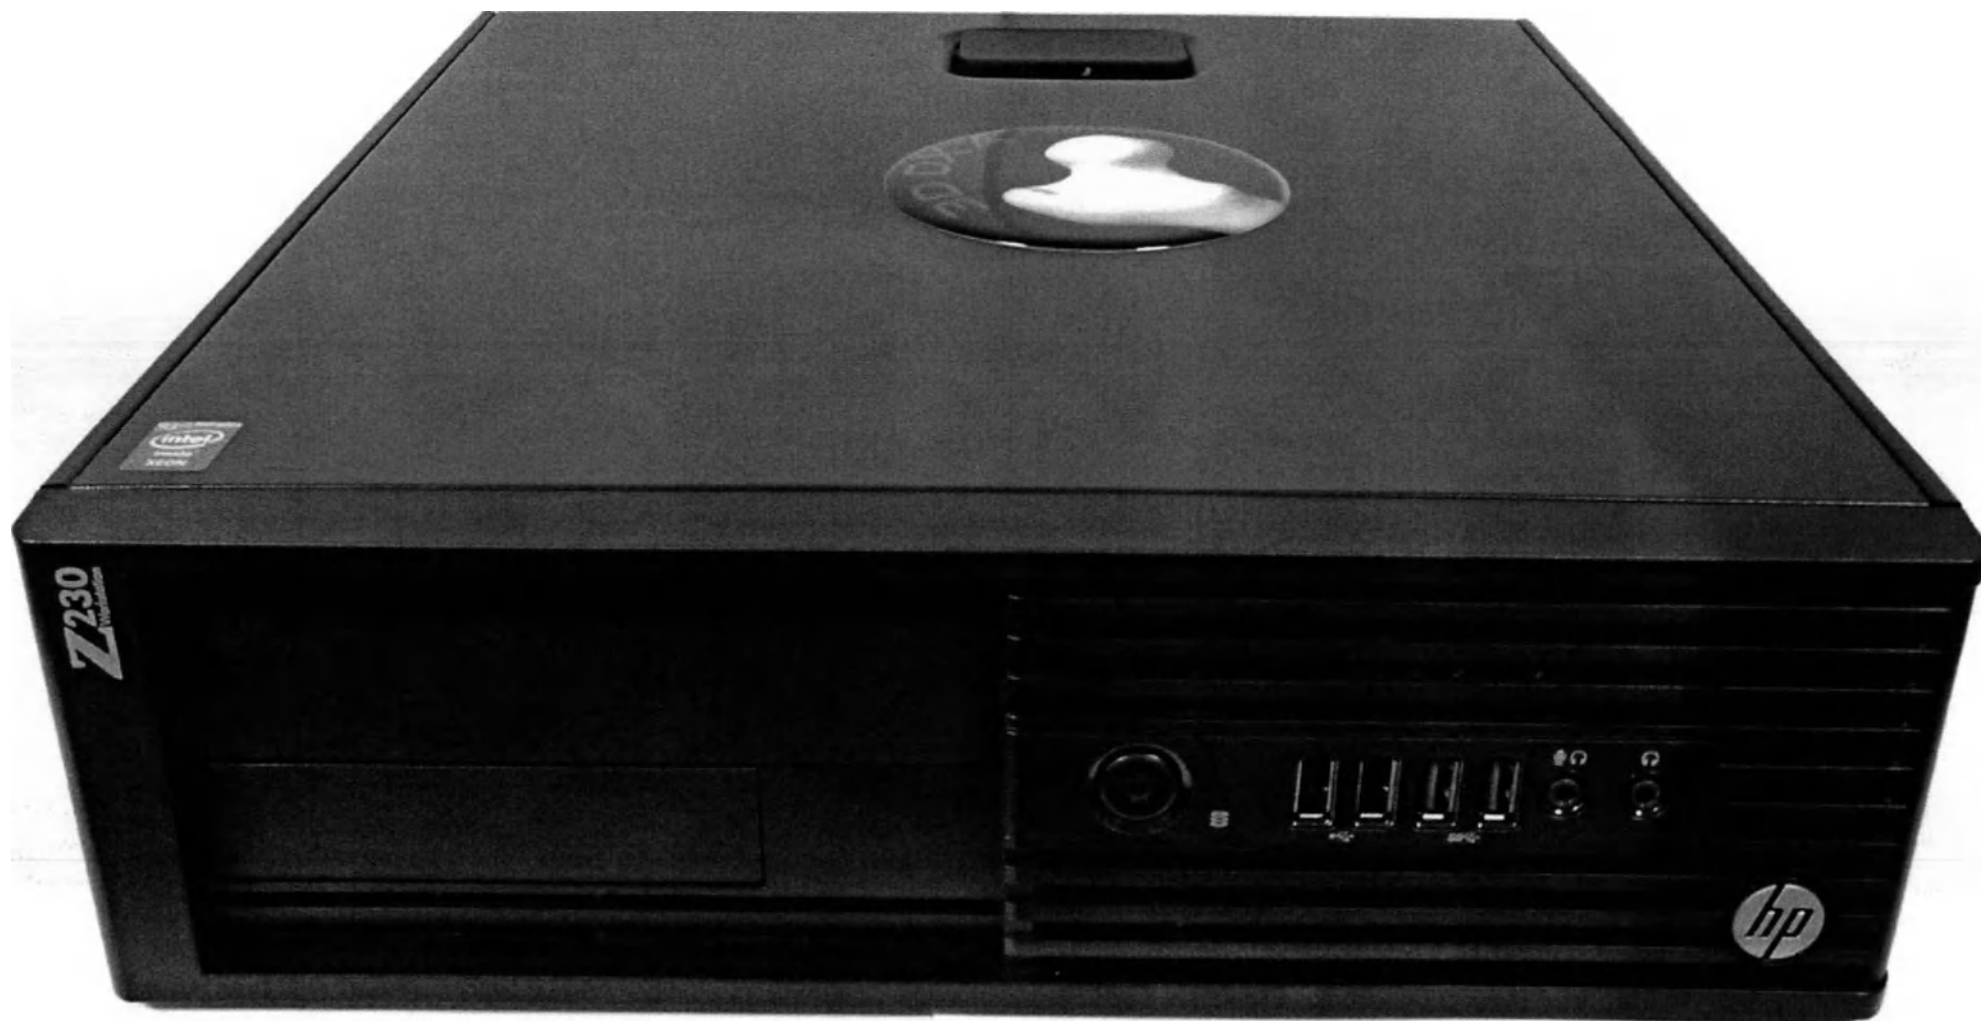


– Модуль 3D-DXA на базе специализированного компьютера



– Кабель питания для модуля



– Сетевой кабель LAN (3м, кат.6Е)

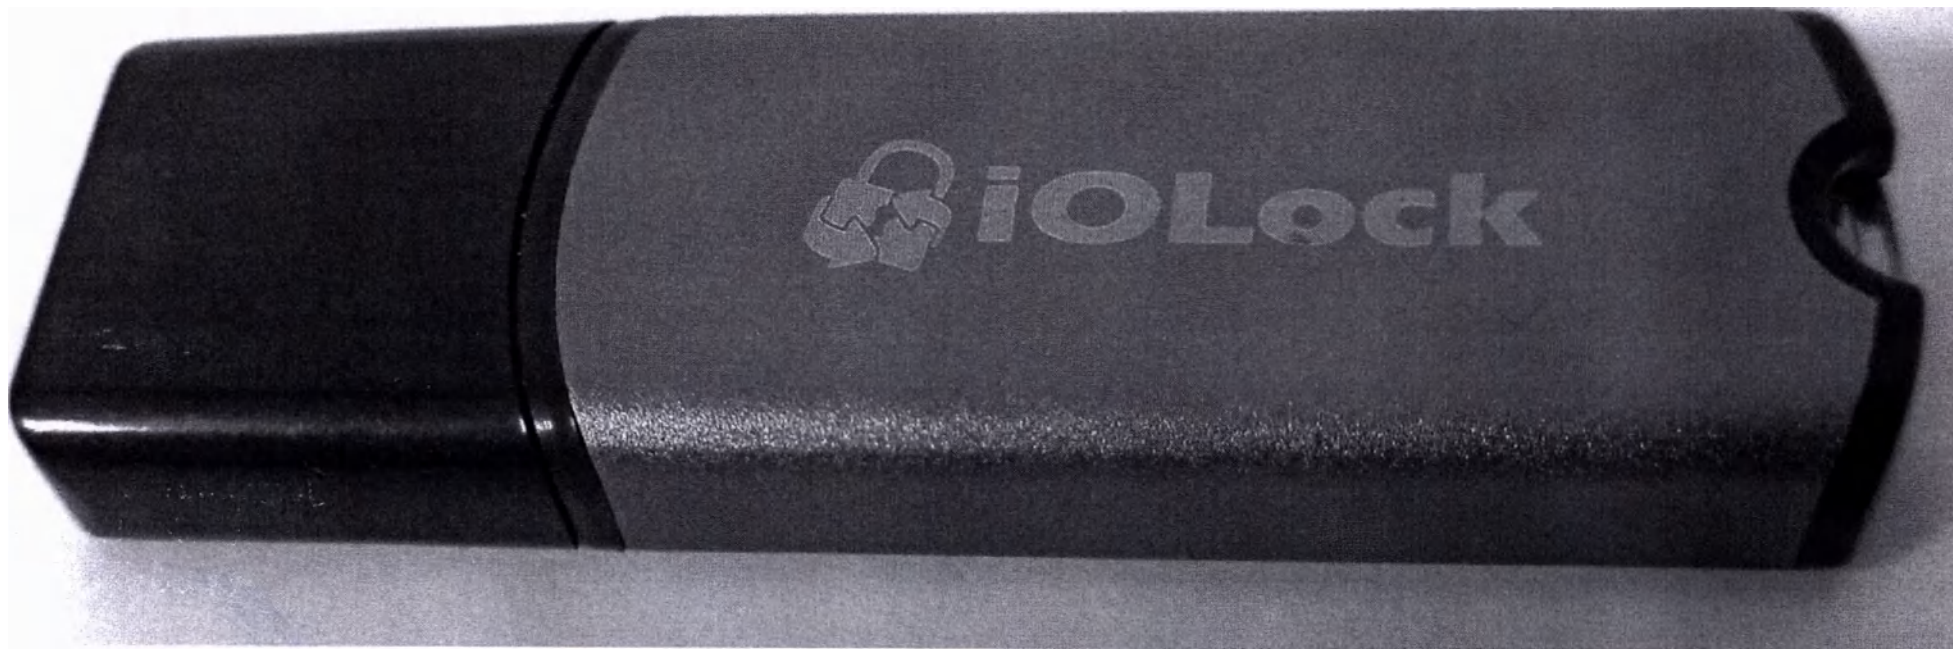

– Лицензионный USB-ключ

Прошито, пронумеровано

и скреплено печатью

47 (сорок семь) листов

генеральный директор
ООО "Асвомед"
С.Н.

