



Фотографии медицинского изделия
Комплекс рентгеновский диагностический
телеуправляемый «Триумф»,
производства ООО «ВКО Медпром», Россия

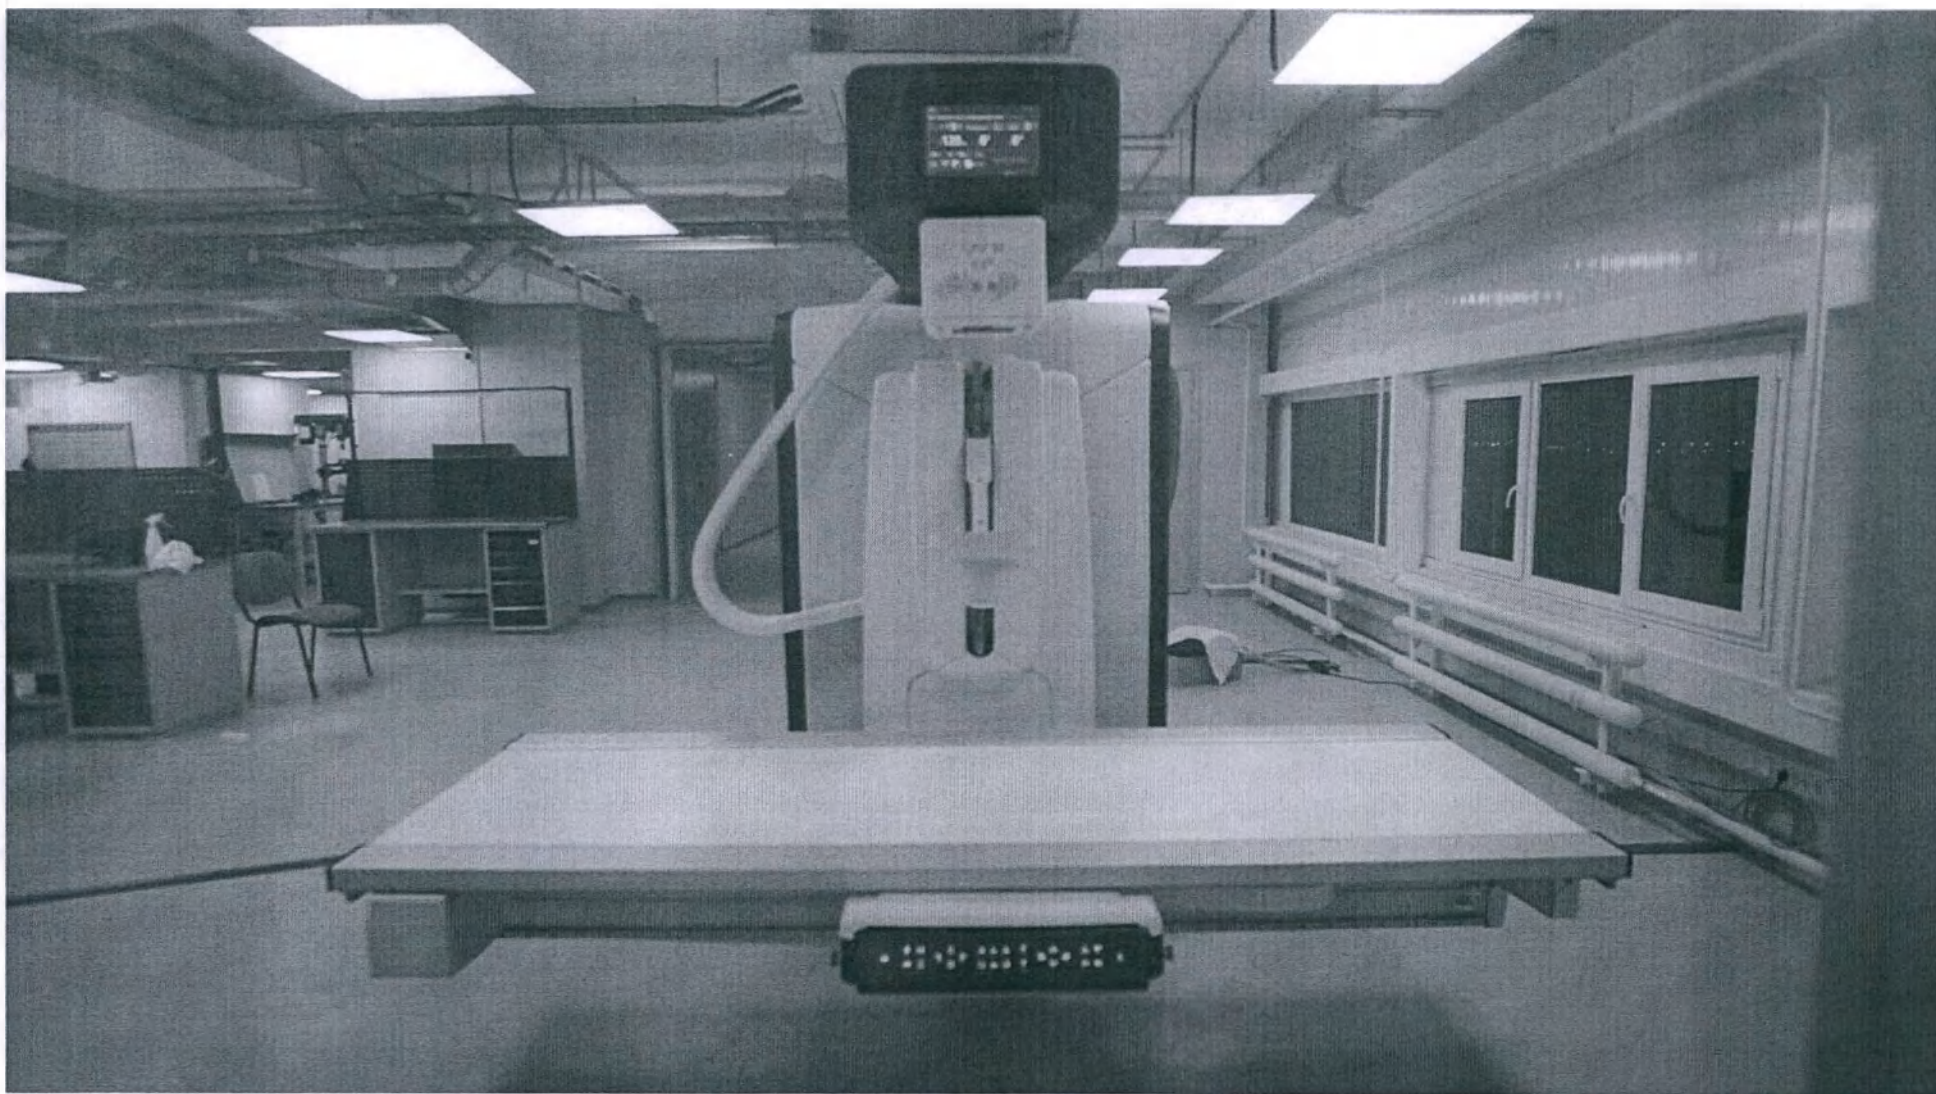

Стол телеуправляемый, (с возможностью перемещения деки в двух или четырех направлениях, с лифтом стола или без лифта стола) T1-B0200, производства ООО «ВКО Медпром», Россия

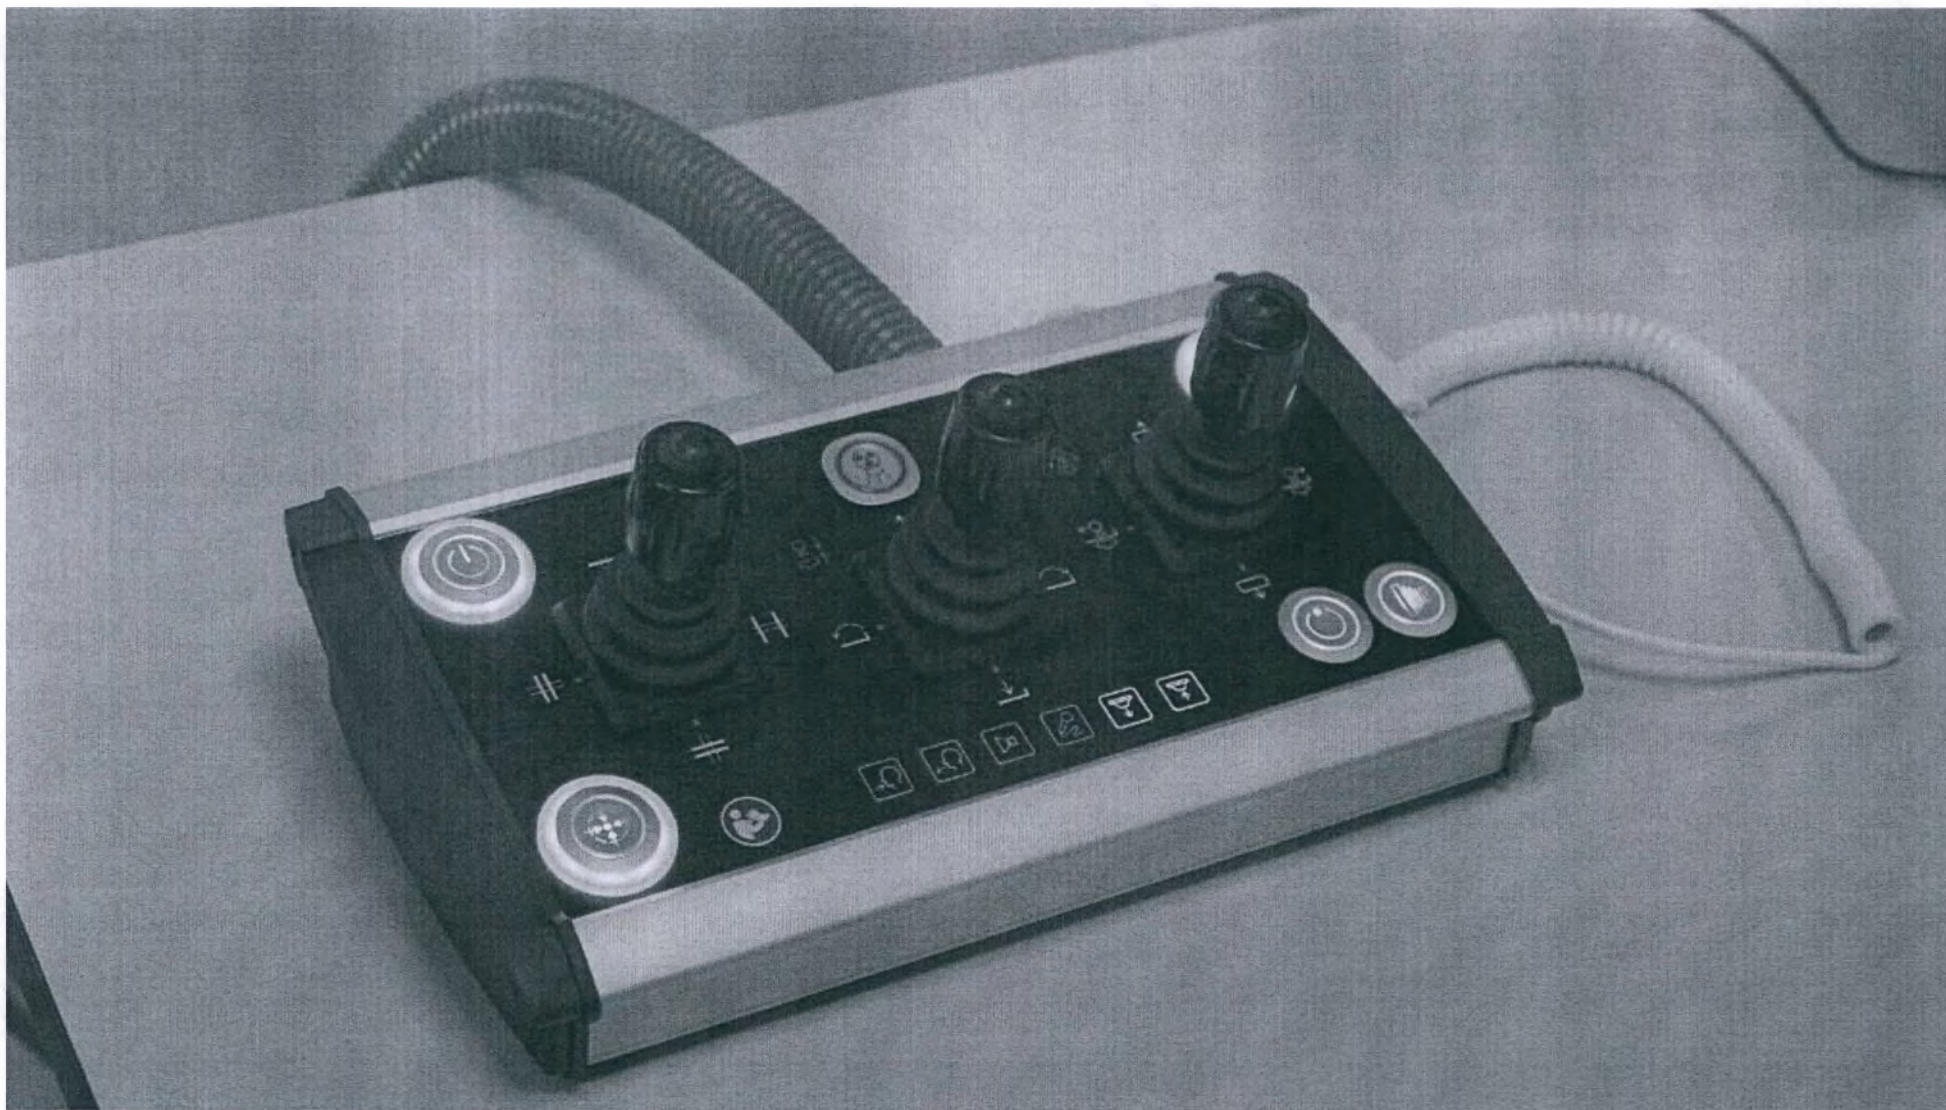


Пульт управления T1-B0300, производства ООО «ВКО Медпром», Россия




Консоль управления T1-B0700, производства ООО «ВКО Медпром», Россия




Устройство управления беспроводное, производства ООО «ВКО Медпром», Россия

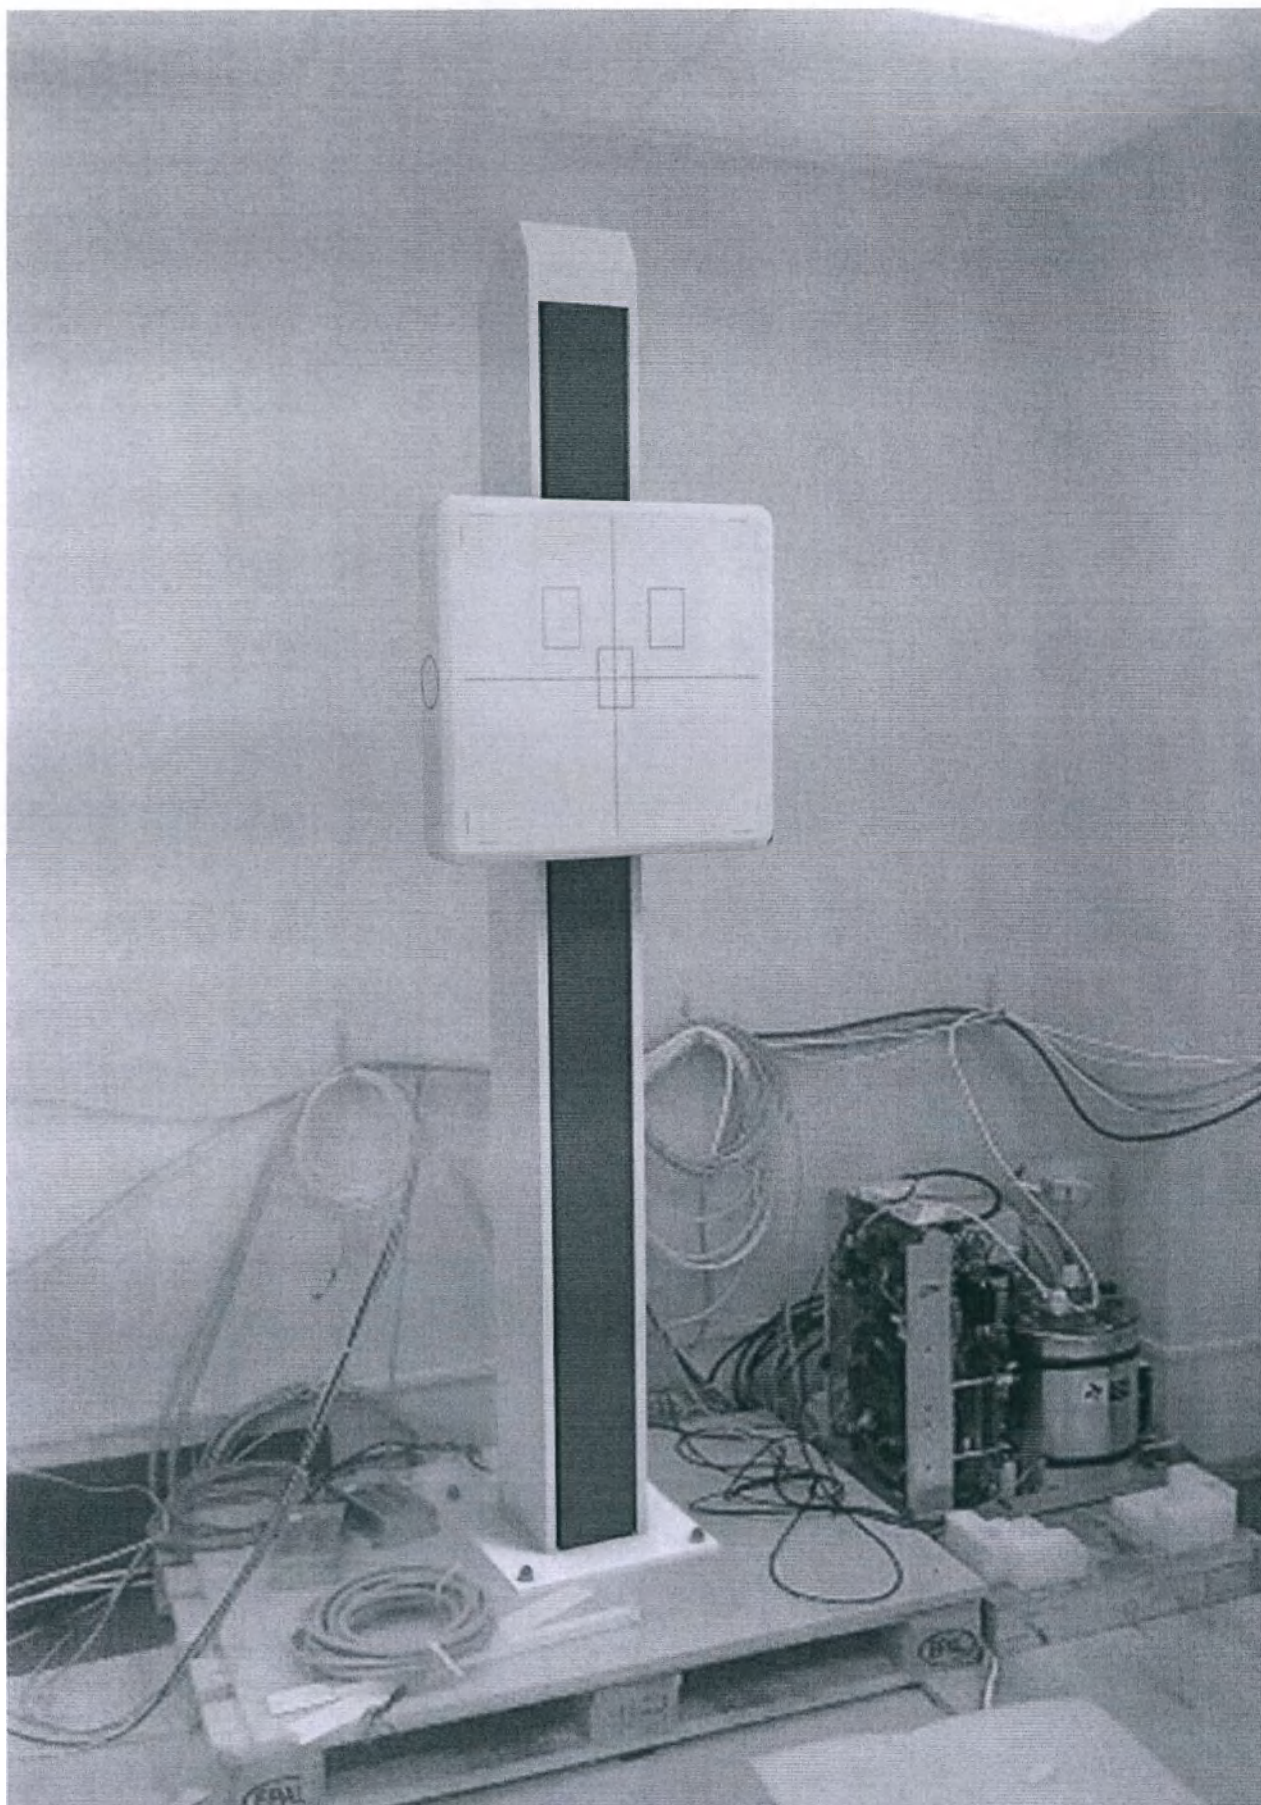


Стойка снимков цифровая А1-В0100, производства ООО «ВКО Медпром», Россия

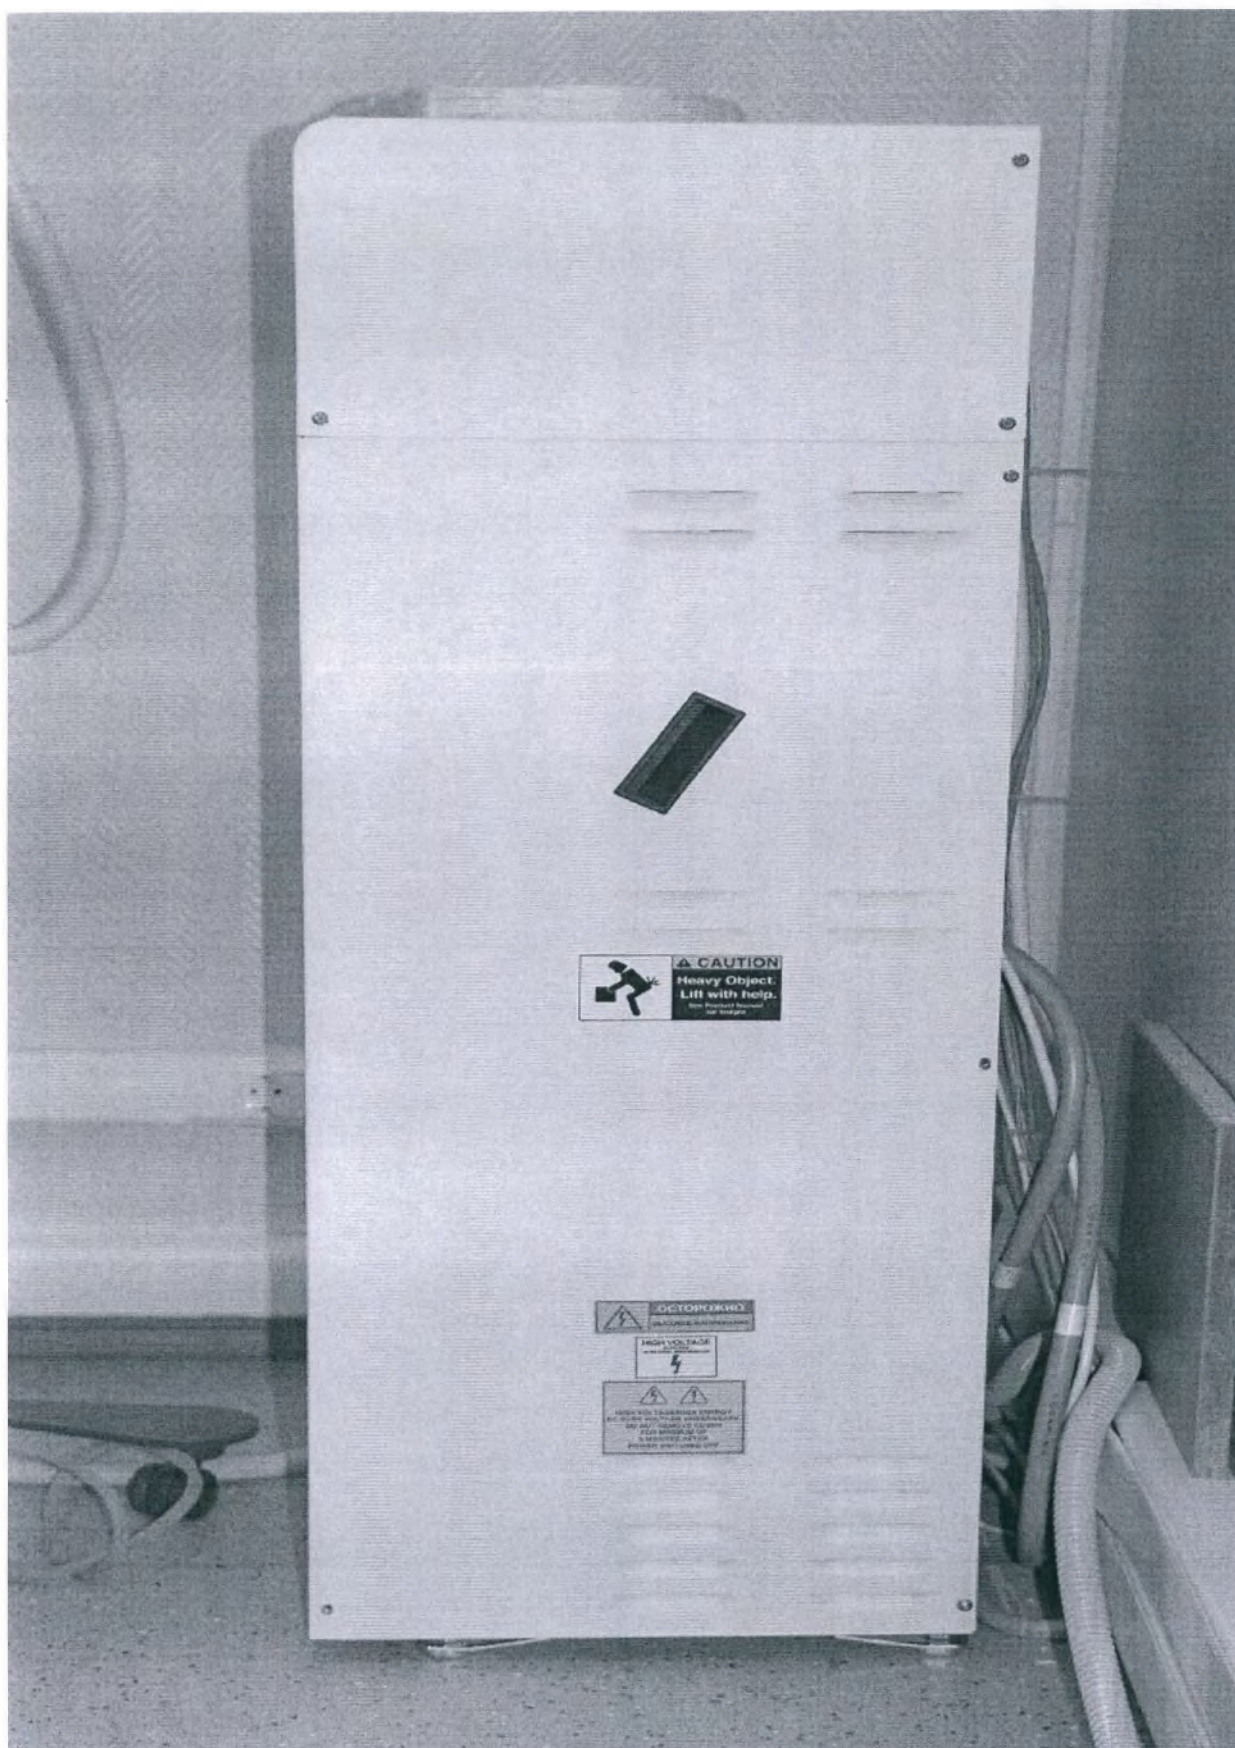


Рентгеновское питающее устройство (РПУ) INDICO IQ 50 kW или INDICO IQ 65 kW или INDICO IQ 80 kW, производства Communications & Power Industries Canada Inc., Канада

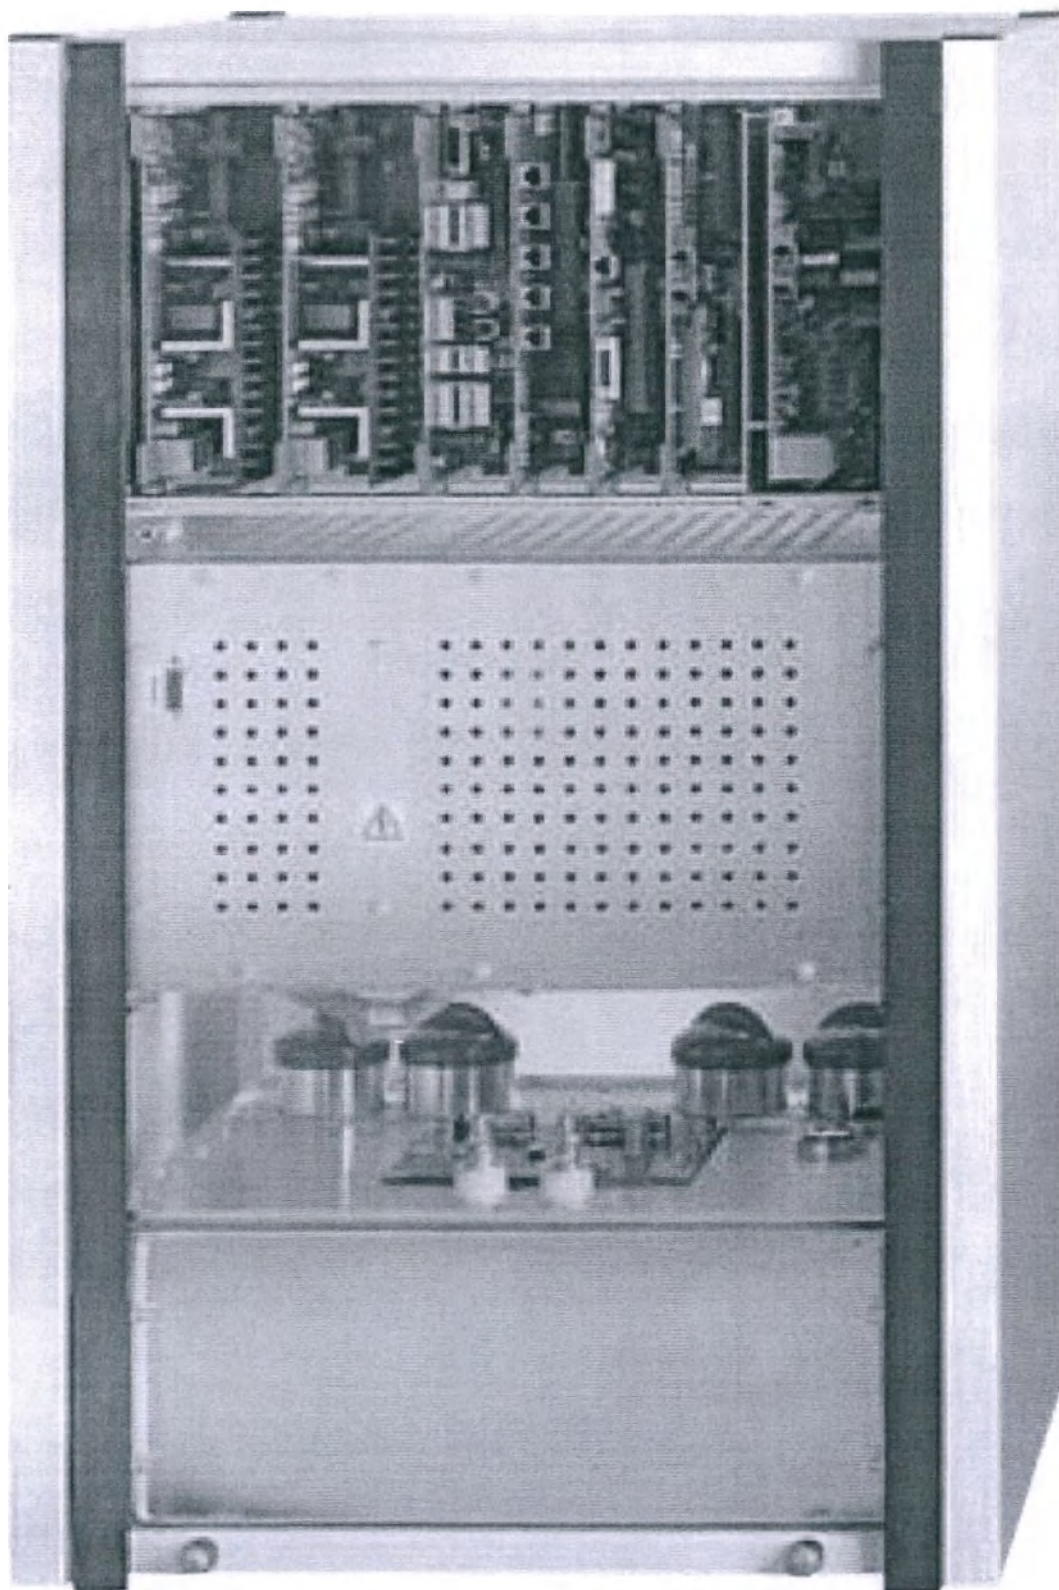


Рентгеновское питающее устройство (РПУ) EDITOR HFe 501 50 kW или EDITOR HFe 601 65 kW или EDITOR HFe 801 80 kW производства Spellman, США или Spellman High Voltage Electronics GmbH, Германия

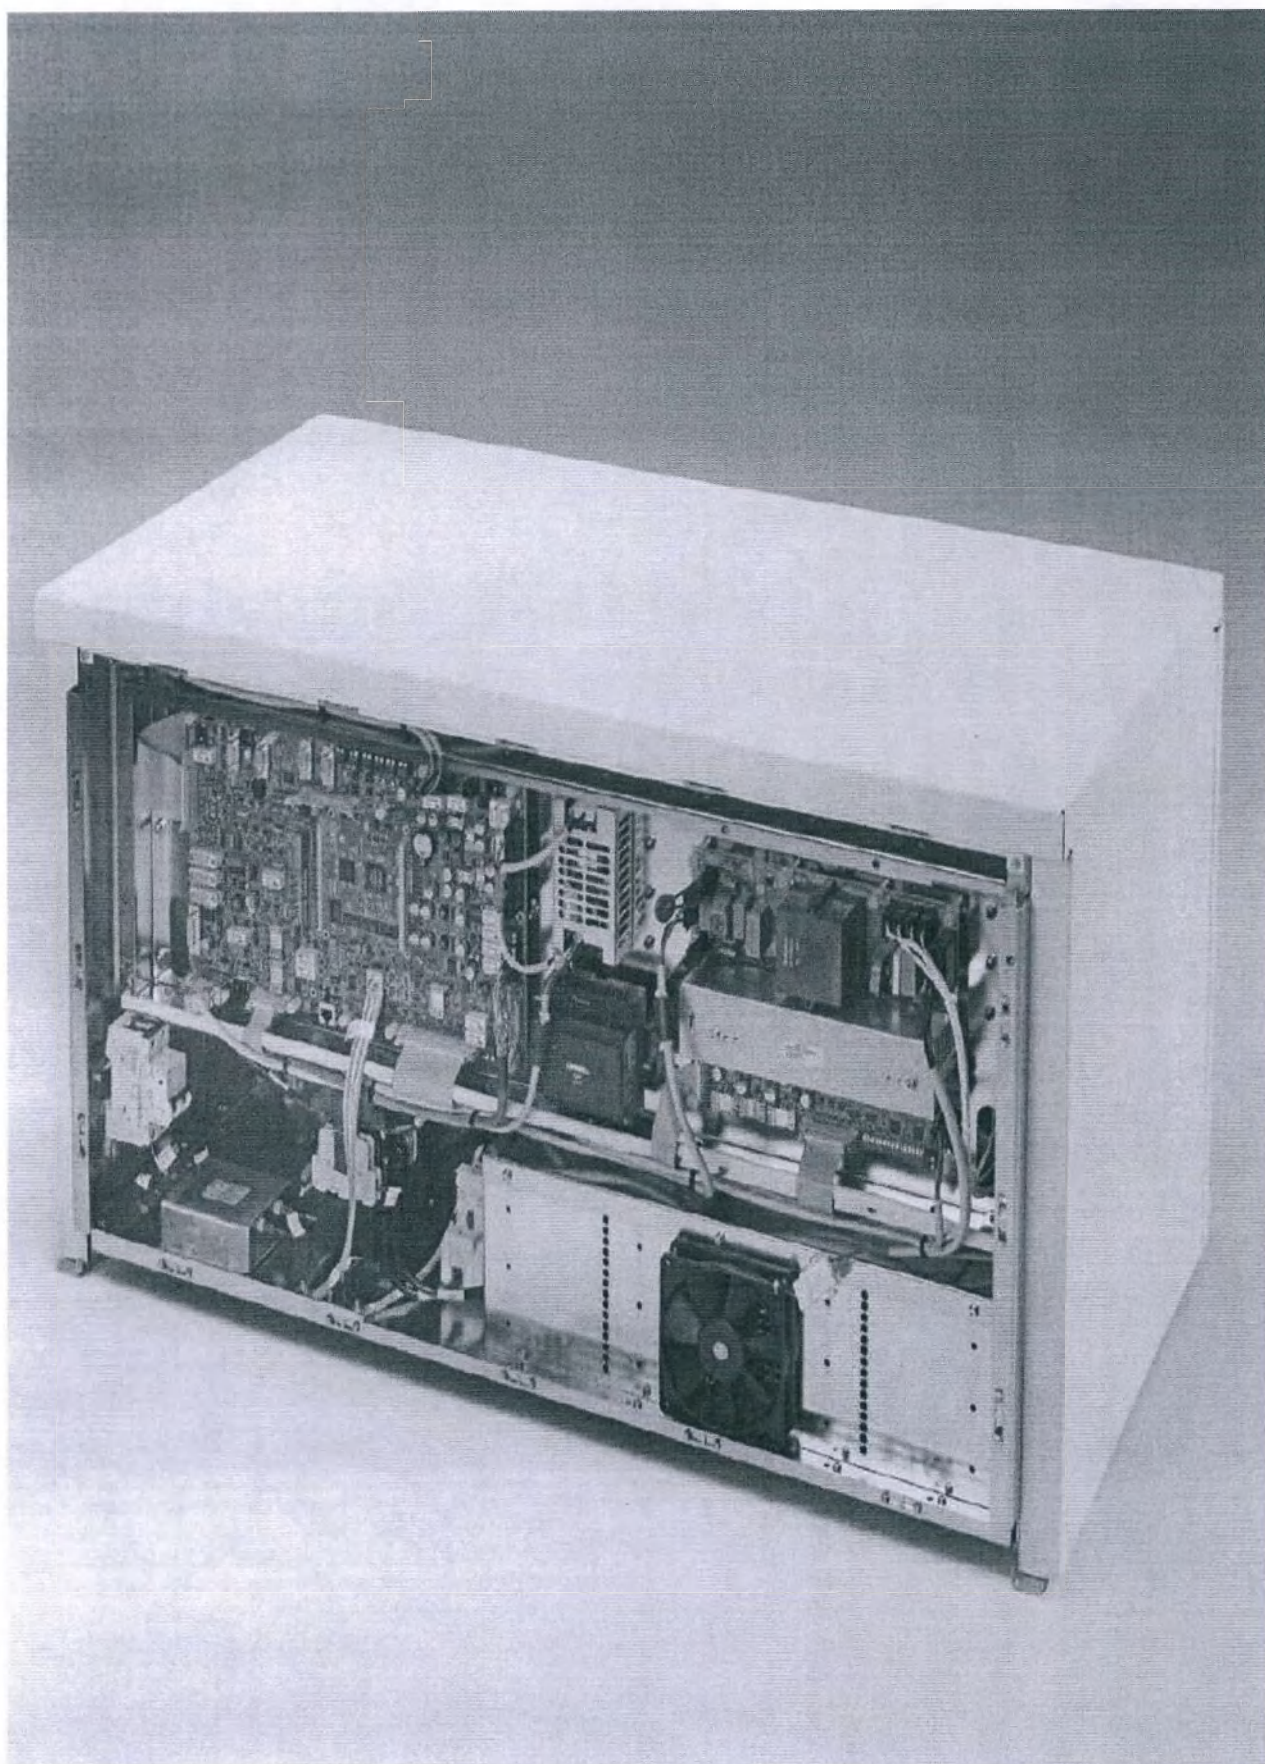


Рентгеновское питающее устройство (РПУ) Polydoros RF 80 55kW или Polydoros RF 80 65kW или Polydoros RF 80 80kW производства Siemens, Германия

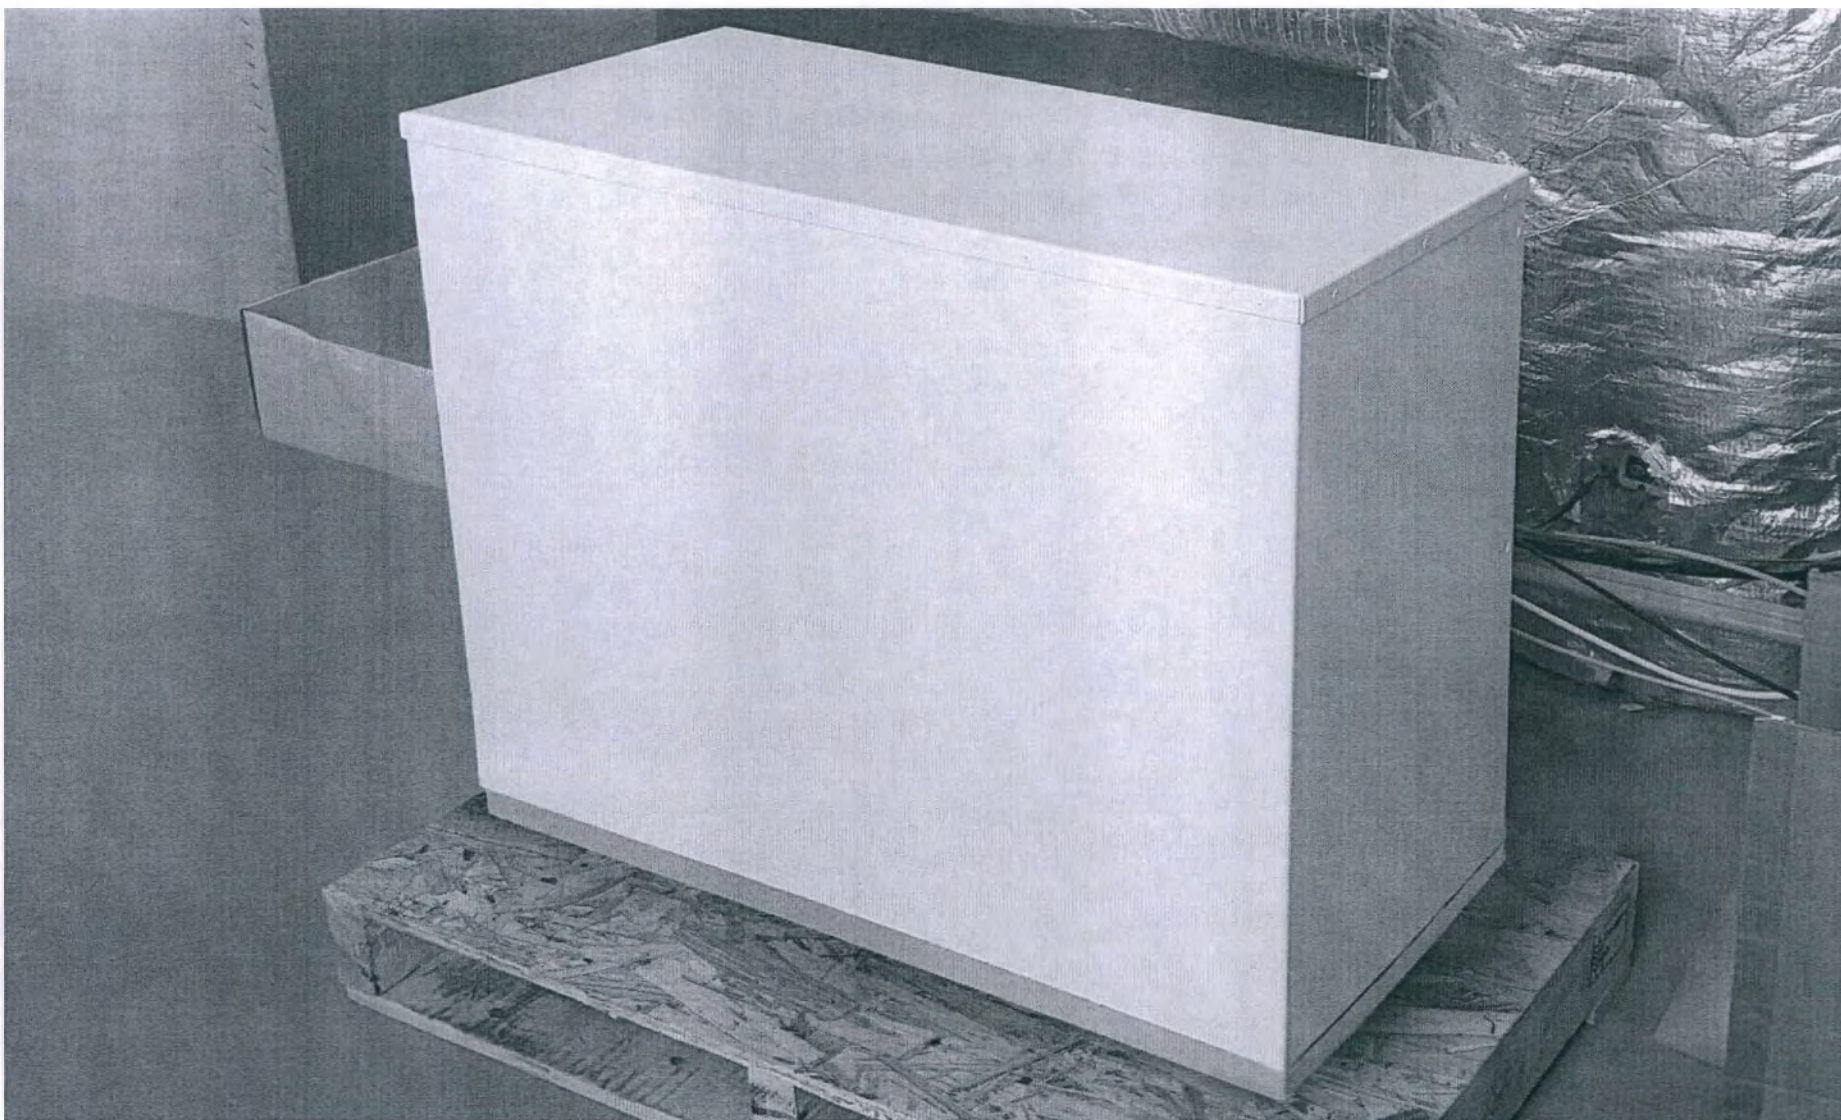


Рентгеновское питающее устройство (РПУ) X1-B0700-01 или X1-B0800-01, производства
ООО «ВКО Медпром», Россия

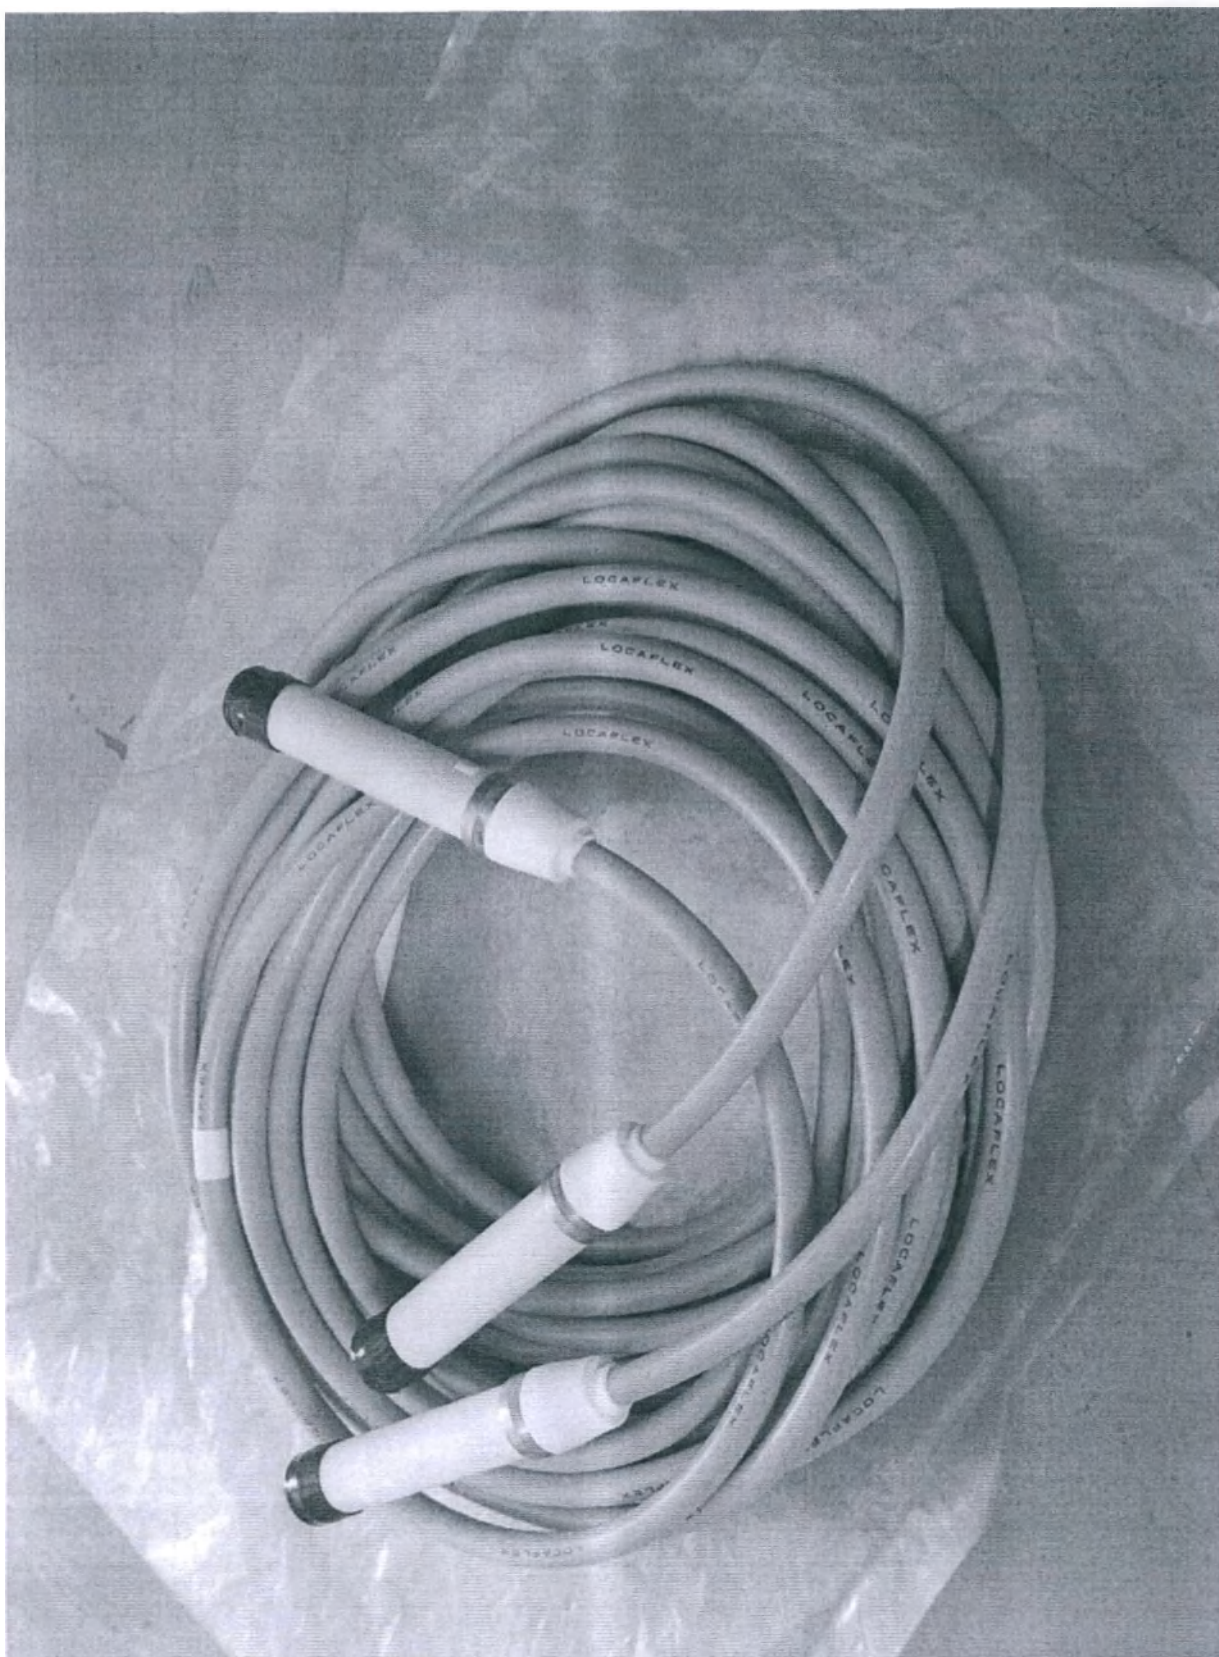


Комплект (пара) кабелей высоковольтных с наконечниками, производства Varex Imaging Nederland B.V., Нидерланды или Varex Imaging Corporation, США или Varex Imaging Corporation, Филиппины или Varex Imaging Corporation, Китай или производства Tianjin Wanbo Wire & Cable Co.,Ltd, Китай

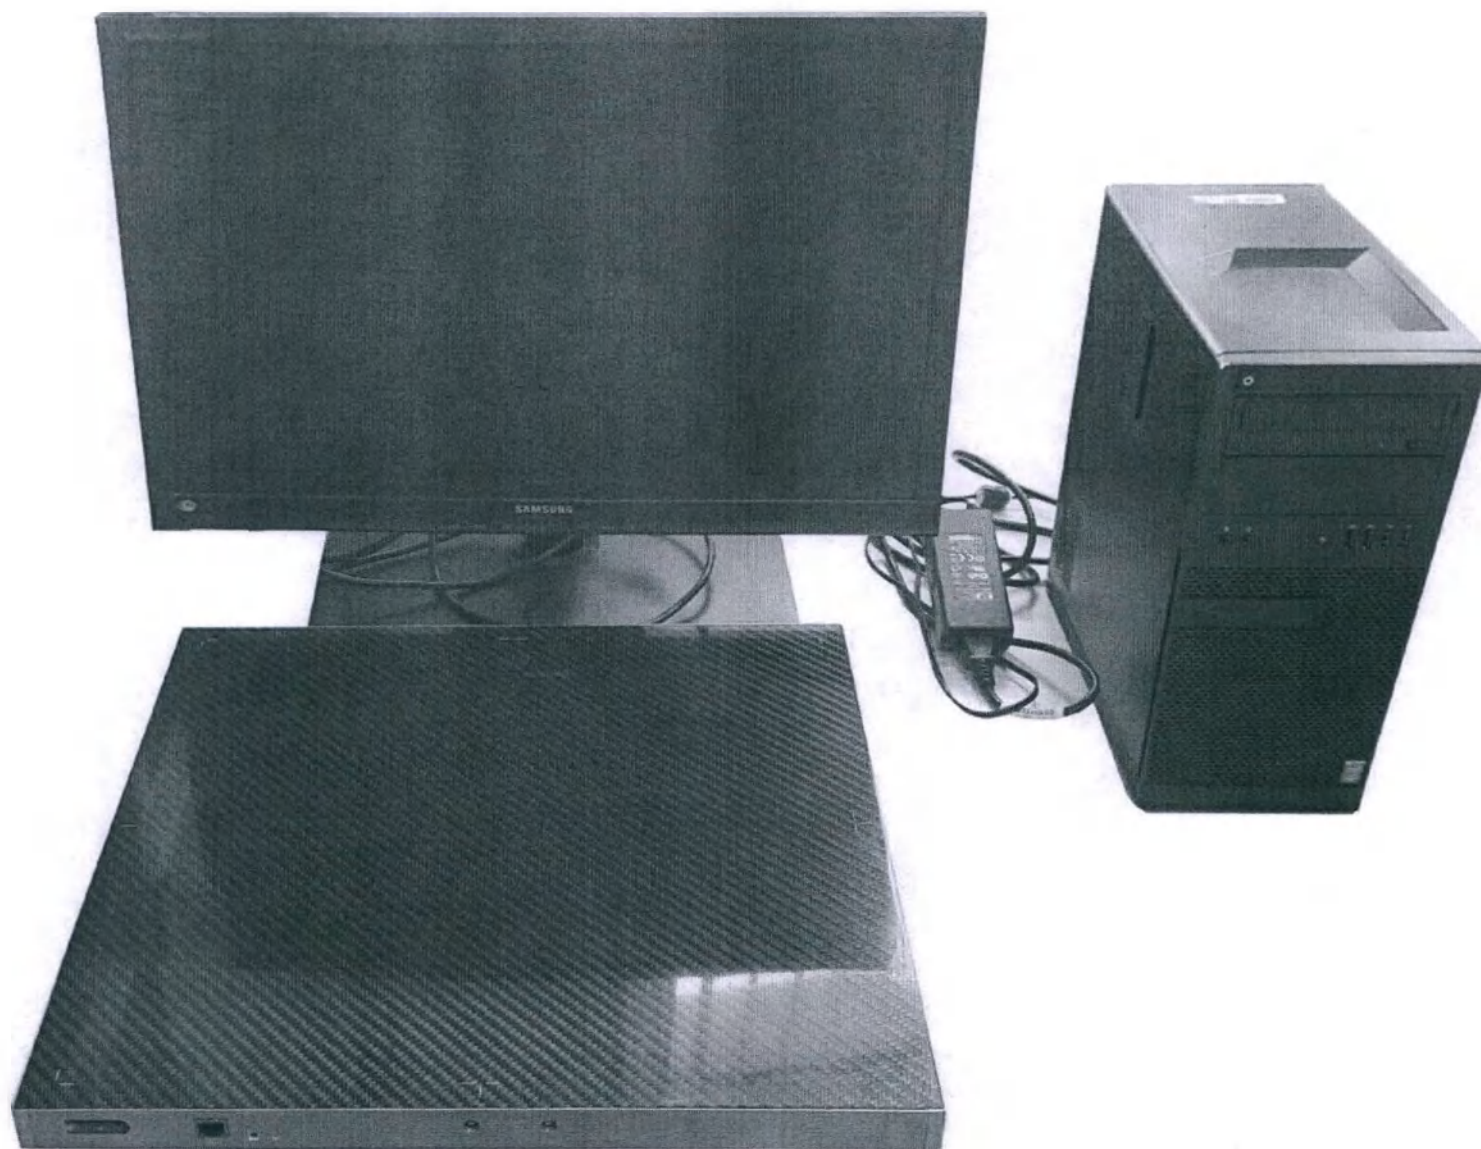


Комплекс аппаратно-программный для регистрации и обработки рентгеновских изображений «СОЛО ДР-МТ», производства АО «МТЛ», Россия

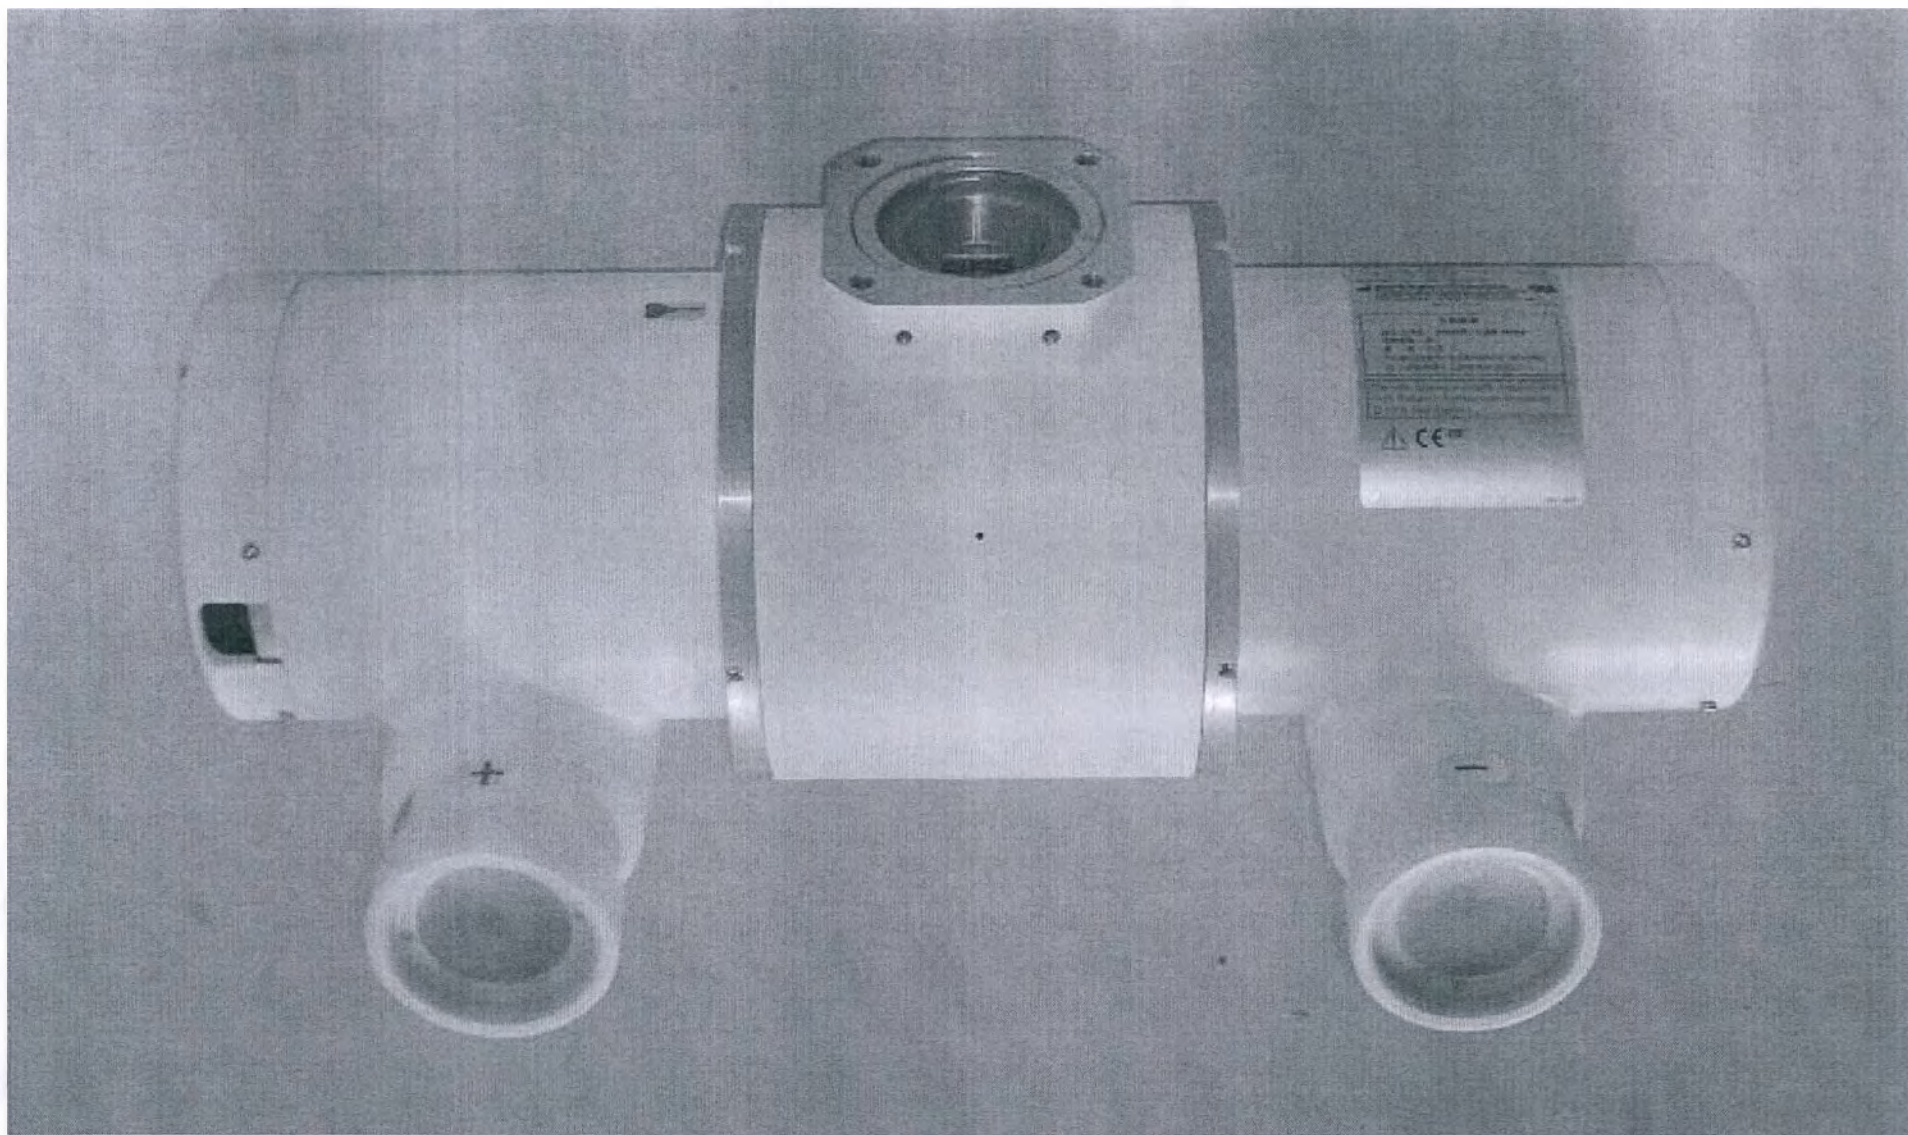


Излучатель рентгеновский с трубкой рентгеновской E7252 X или E7252 FX или E7252 GX или E7869 X или E7864 X, производства Canon Electron Tubes & Devices Co., Ltd, Япония

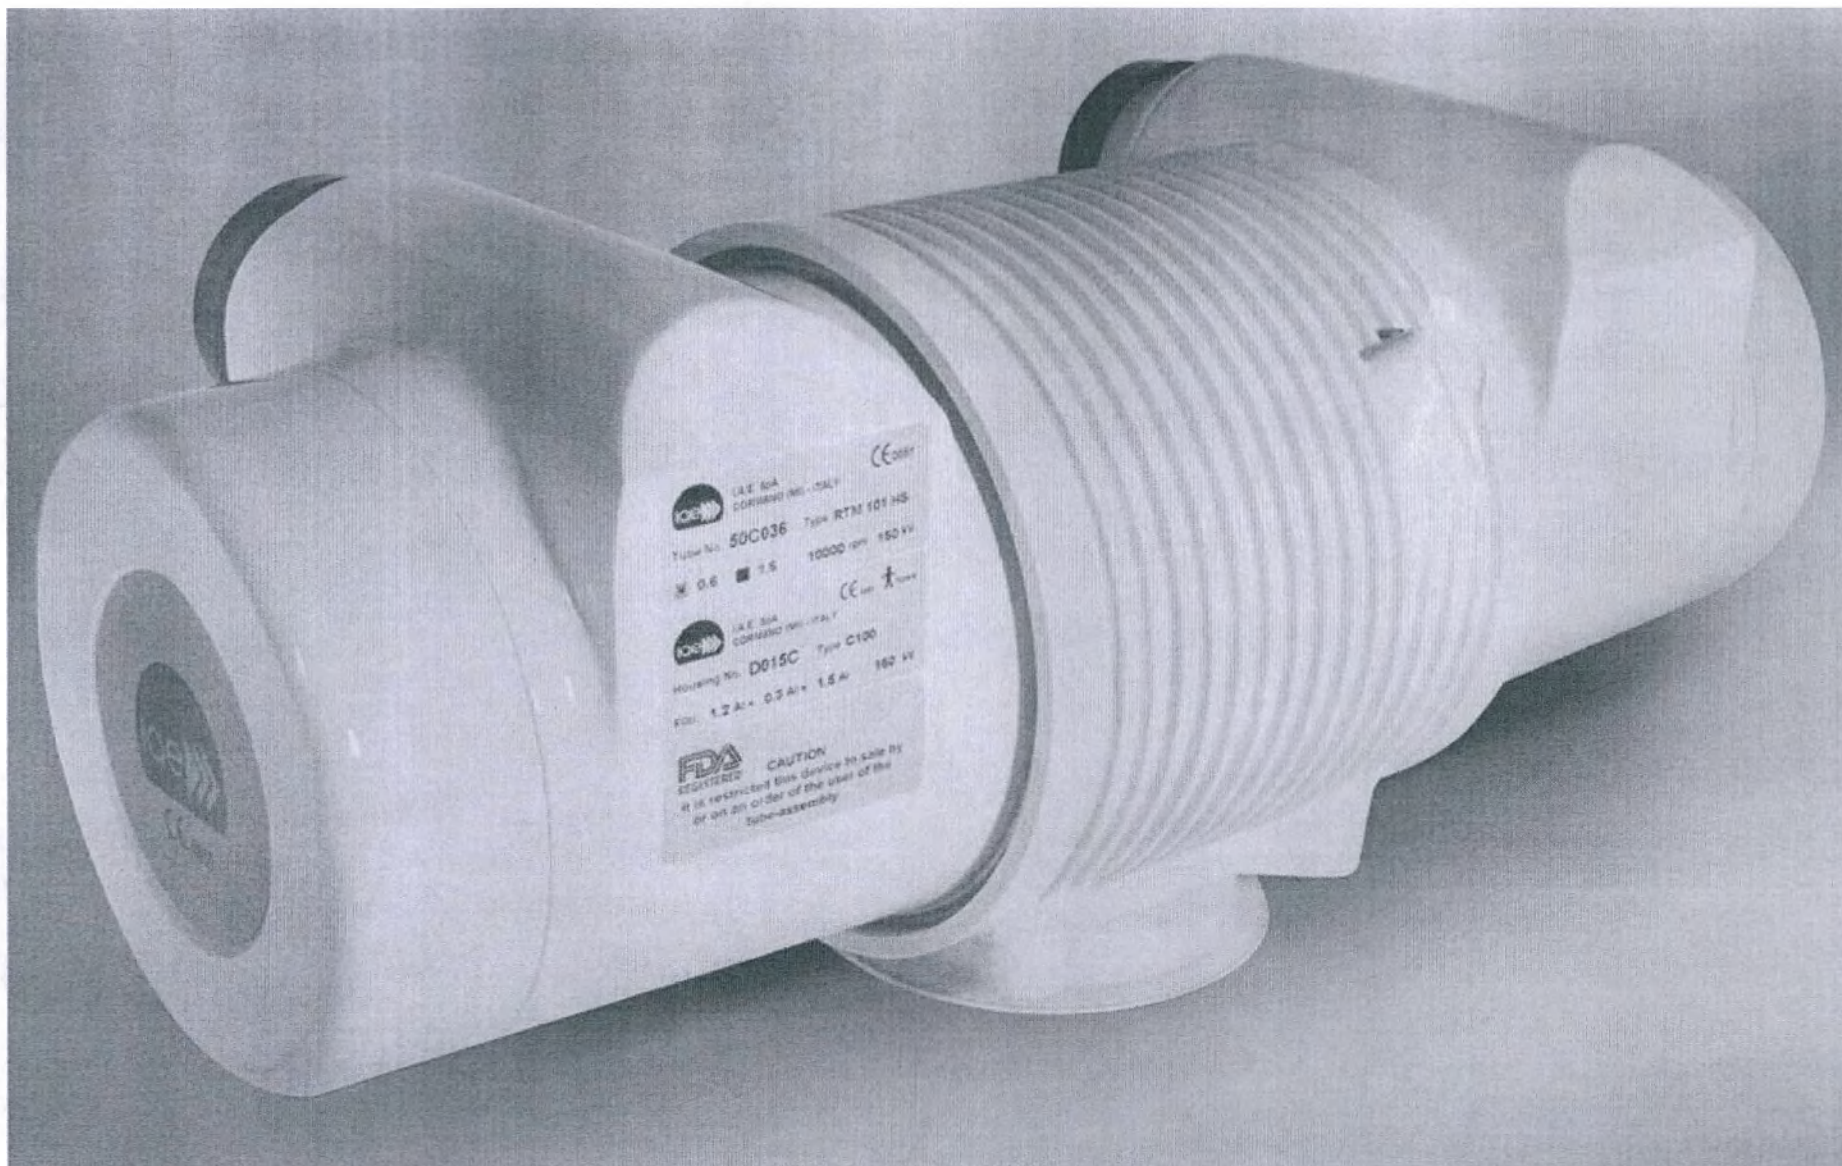


Излучатель рентгеновский с трубкой рентгеновской серии RTM101HS, производства IAE Spa, Италия

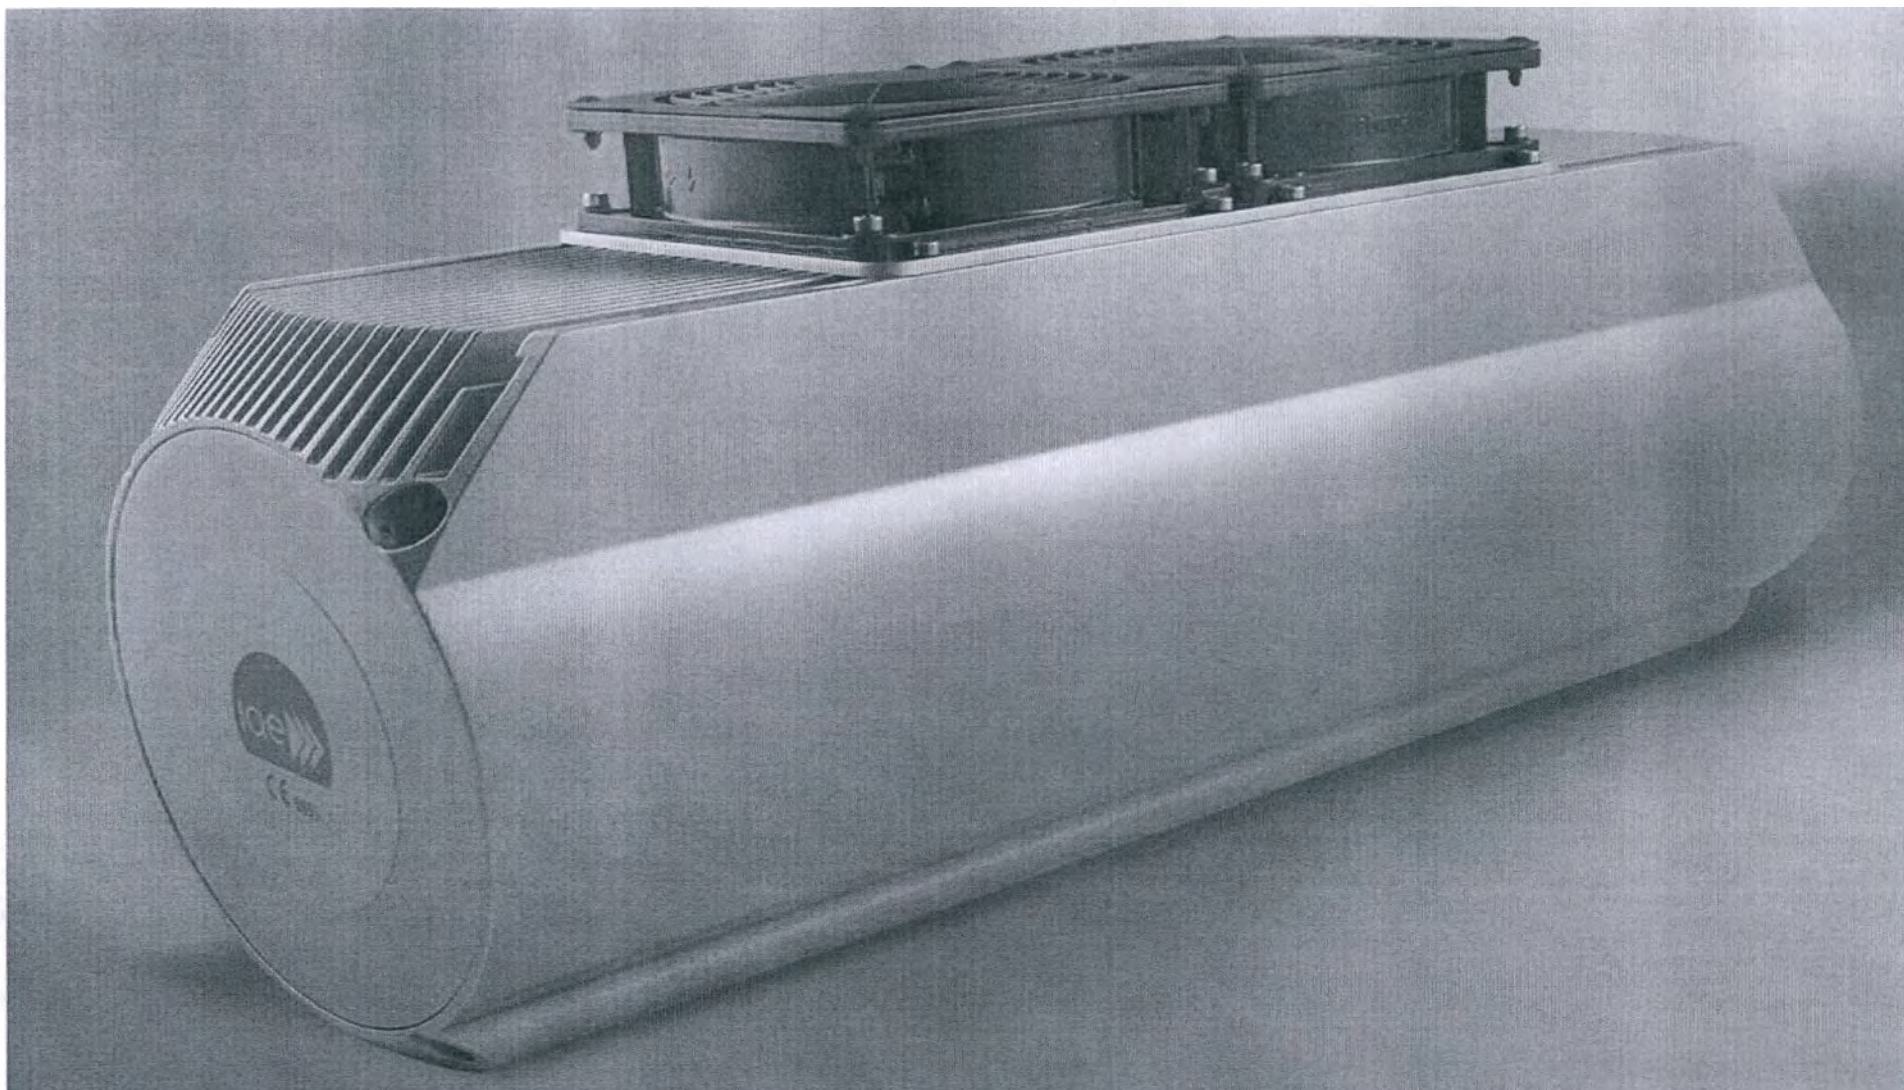


Излучатель рентгеновский с трубкой рентгеновской серии RTC700HS, производства IAE Spa, Италия

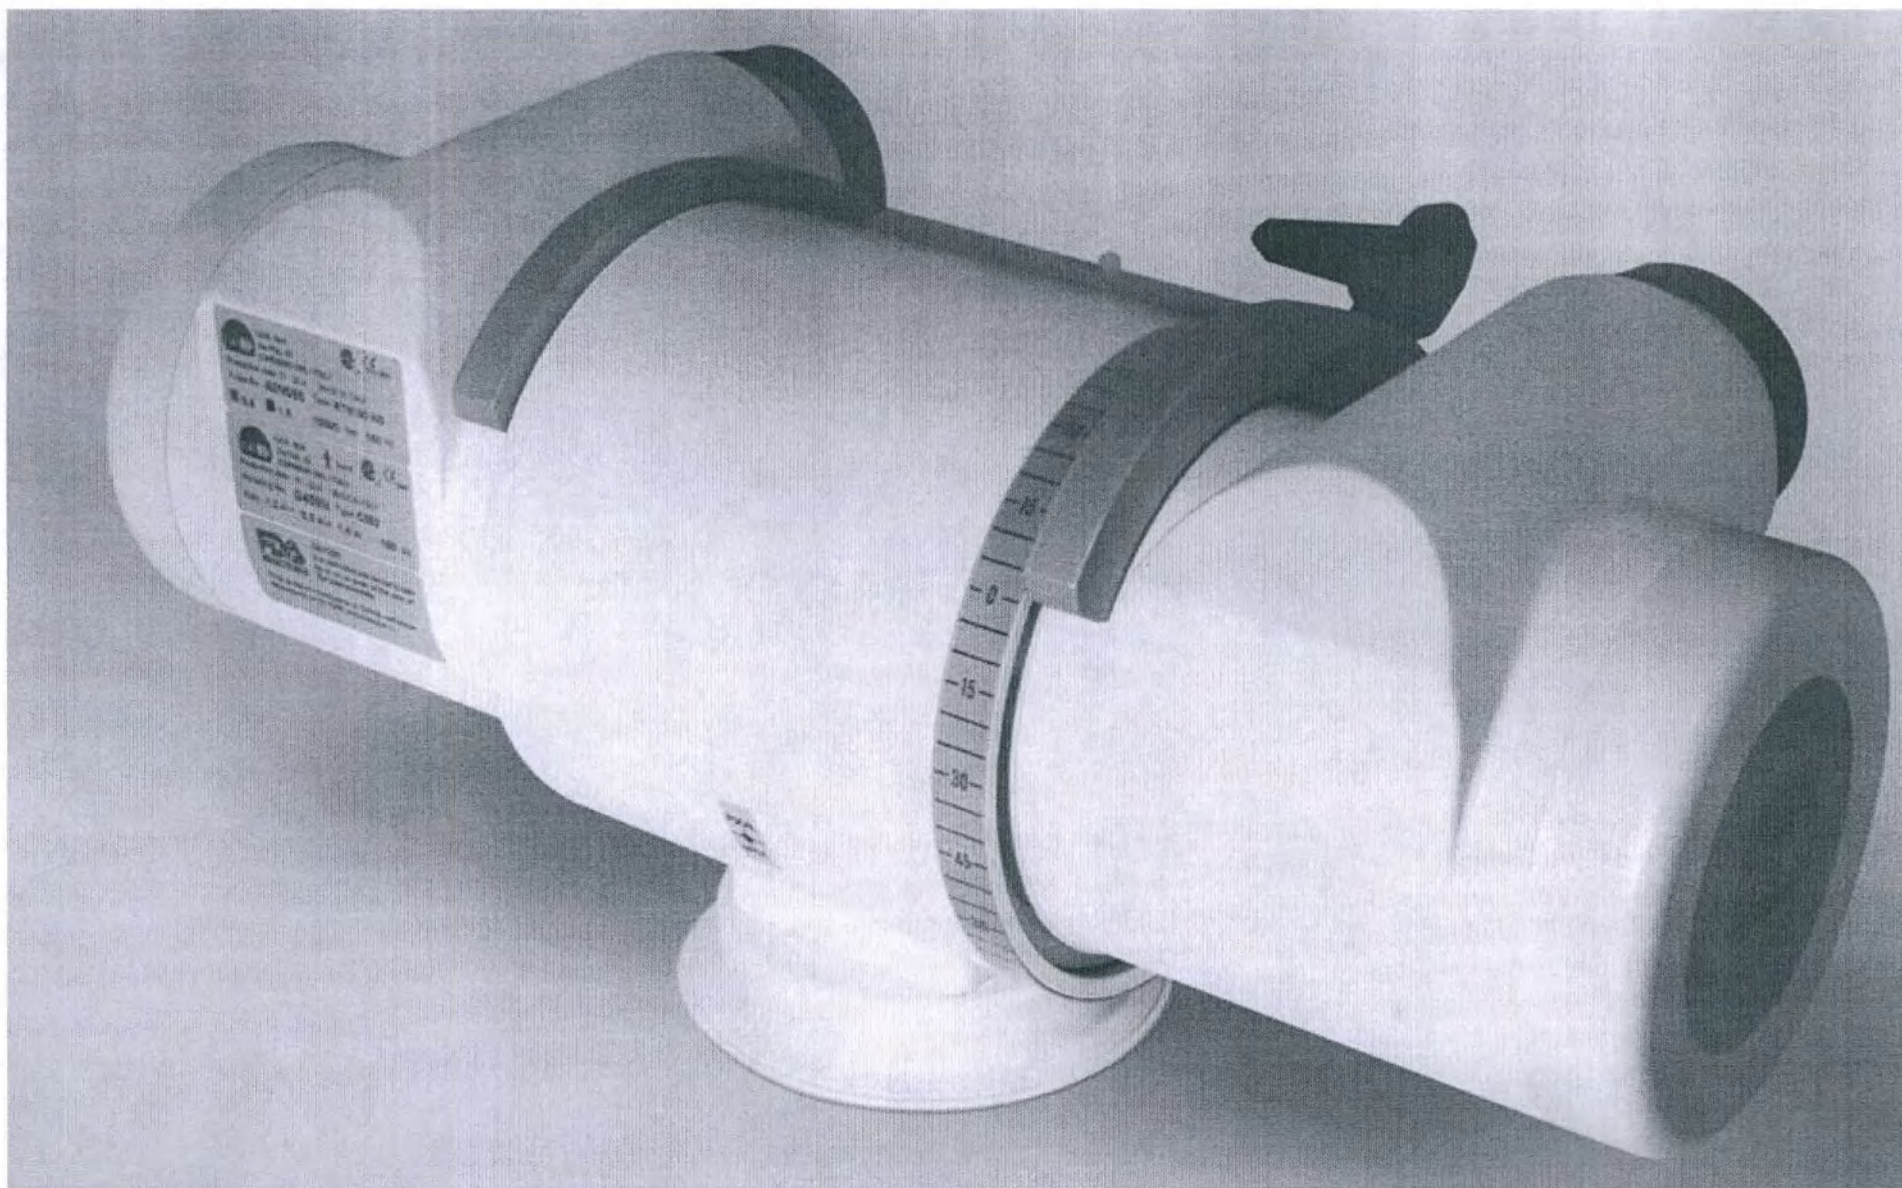


Излучатель рентгеновский с трубкой рентгеновской серии RTM782HS, производства IAE Spa, Италия

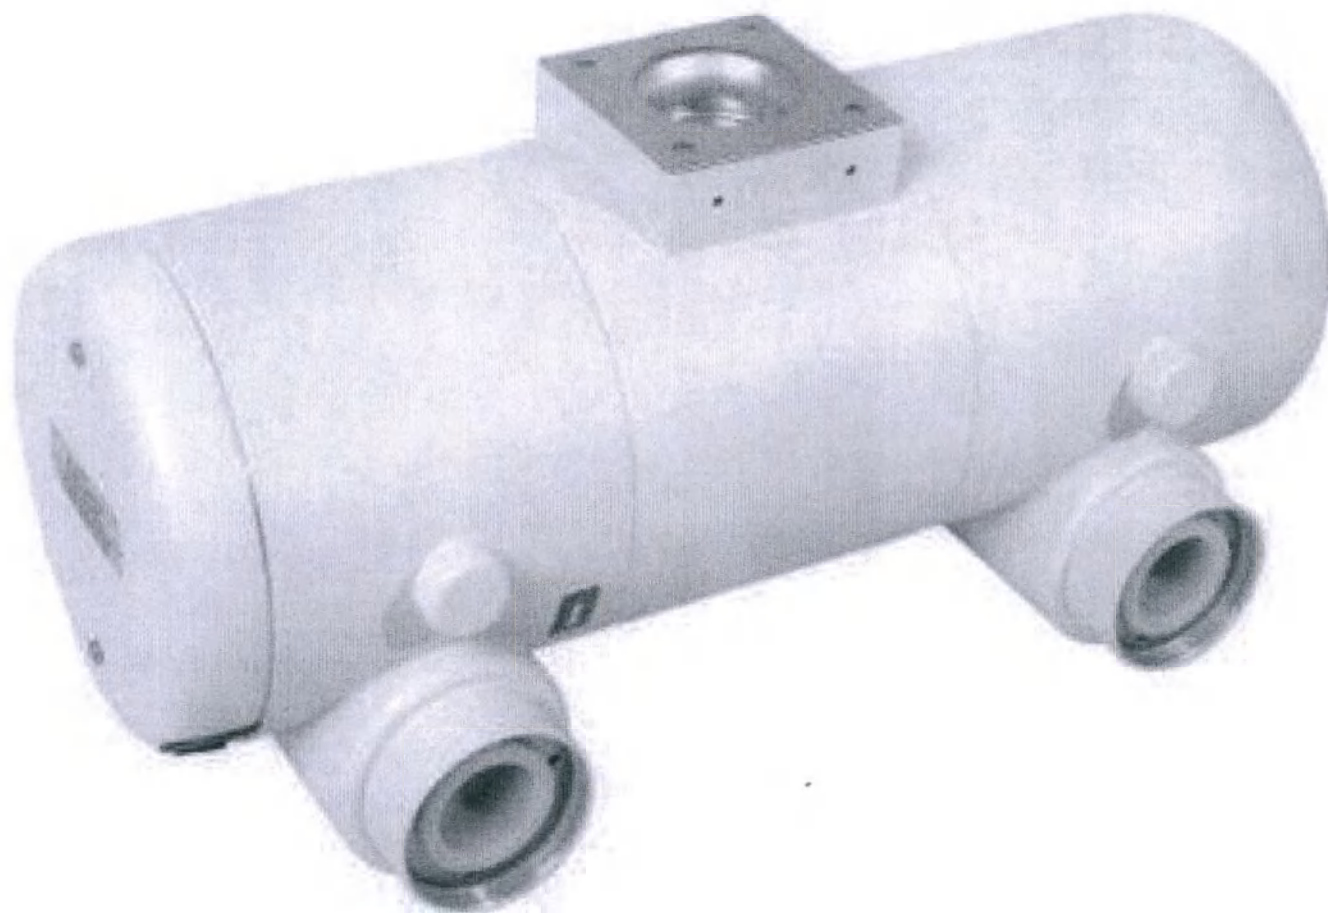

Излучатель рентгеновский с трубкой рентгеновской G-892/B-130 или A-297/B-130 или G-292/B-130H, производства Varex Imaging Nederland B.V., Нидерланды или Varex Imaging Corporation, США

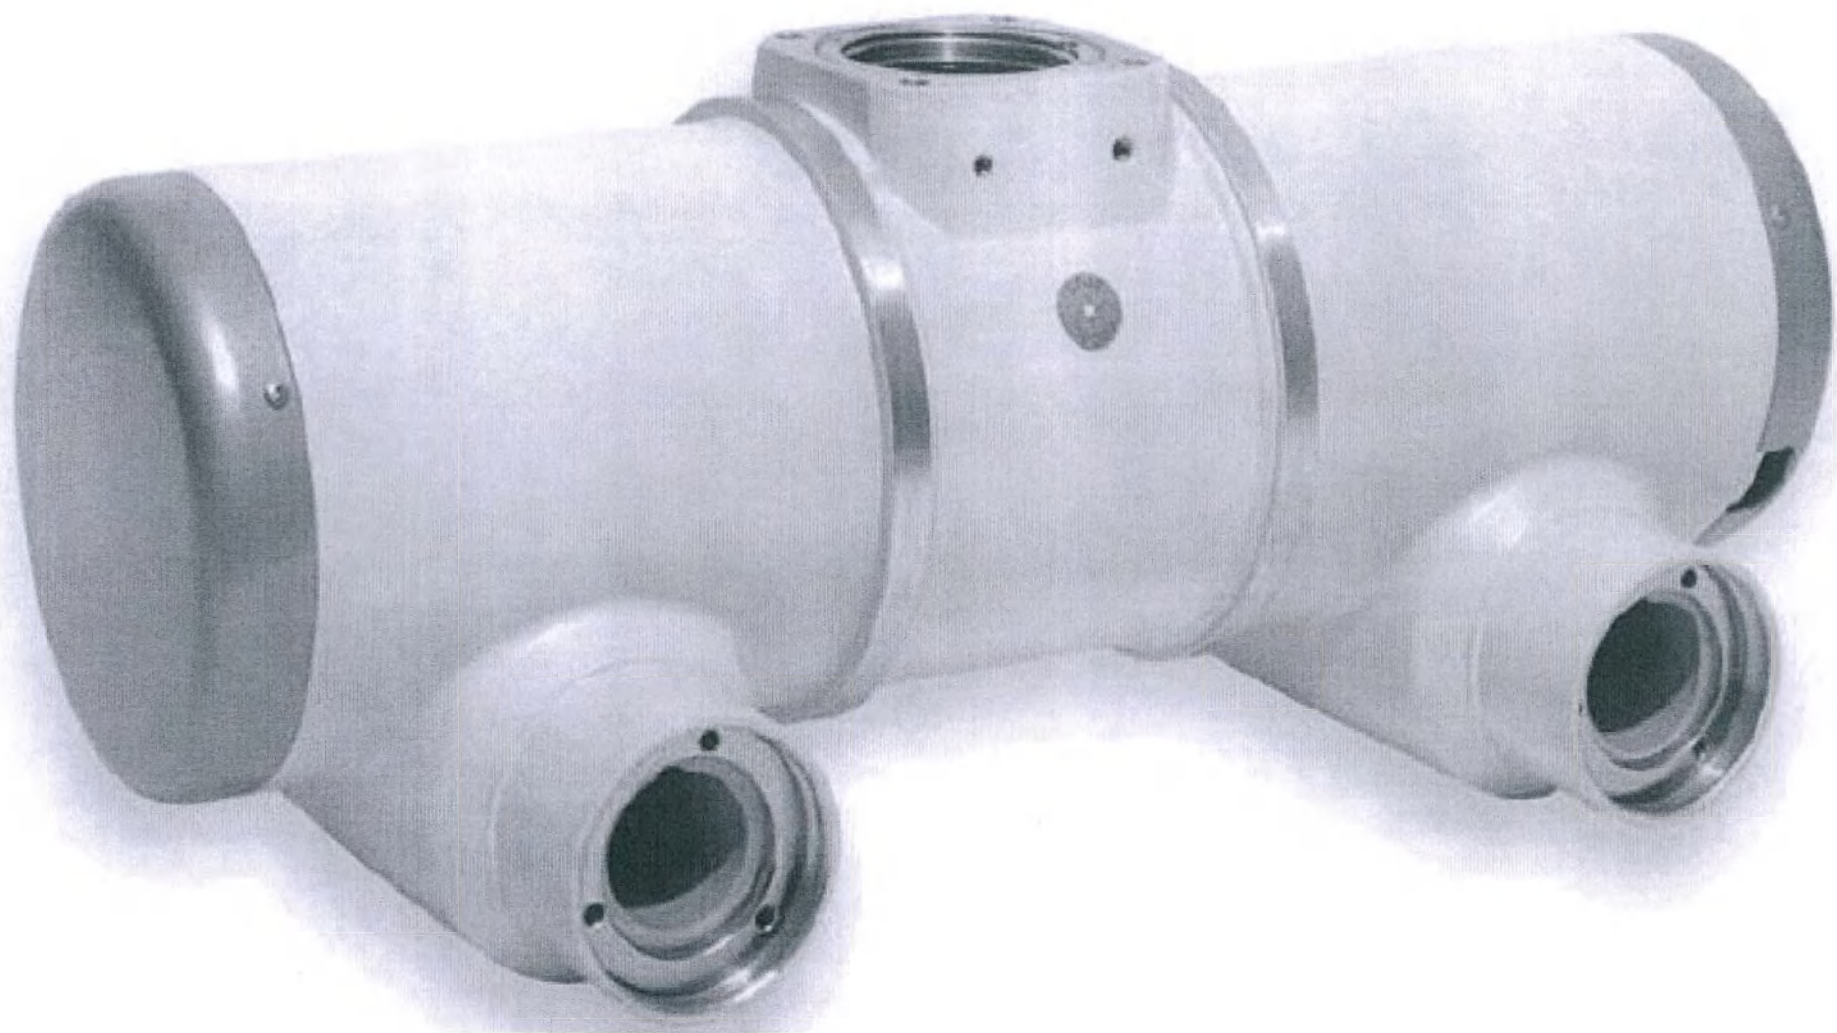


Излучатель рентгеновский с трубкой рентгеновской RAD 14/Leo, производства Varex Imaging Nederland B.V., Нидерланды или Varex Imaging Corporation, США

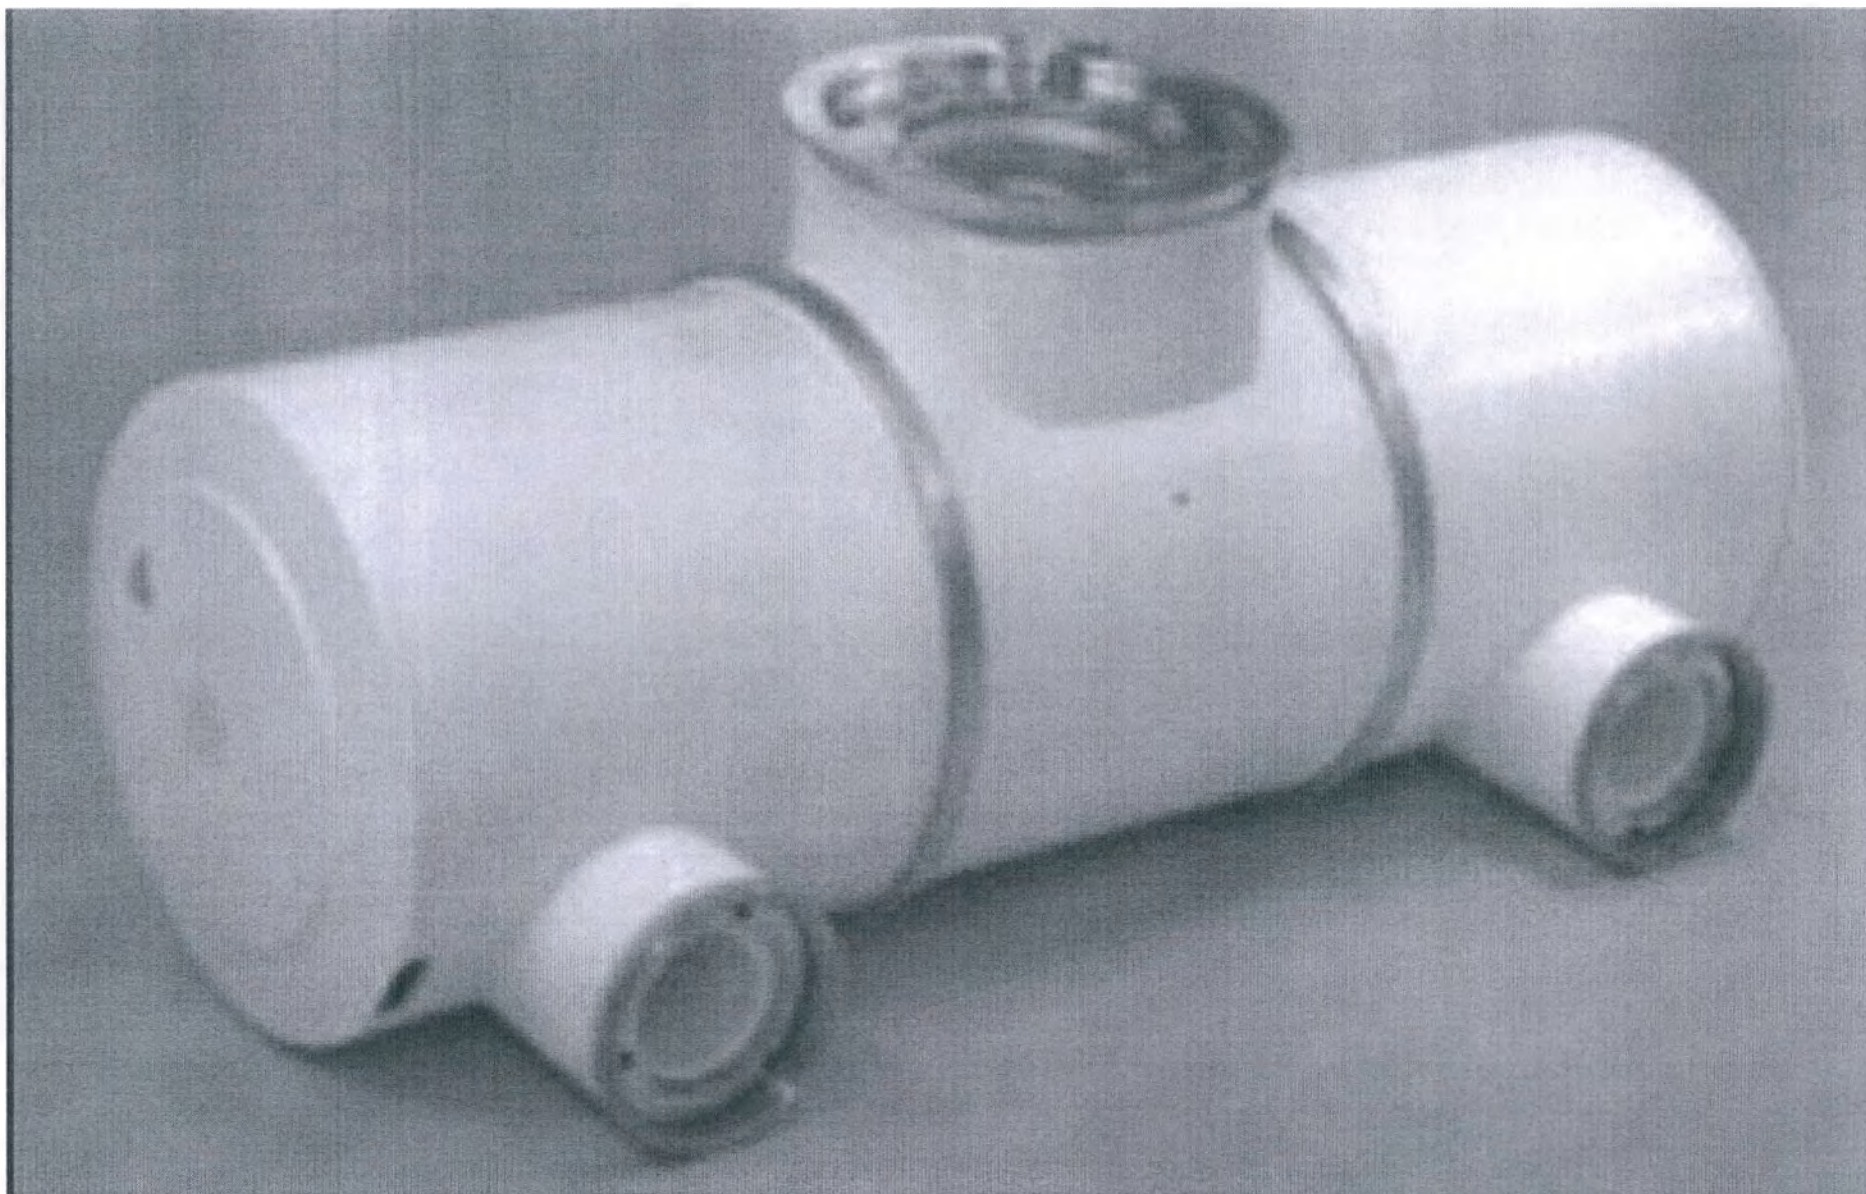


Излучатель рентгеновский с трубкой рентгеновской SV 150/40/80HC-100 или SV 150/40/80C-100
производства Siemens, Германия



Коллиматор с соединительными элементами, с автоматическим или ручным управлением (может комплектоваться автоматическими или ручными сменными фильтрами) R 221 ACS, производства Ralco srl., Италия

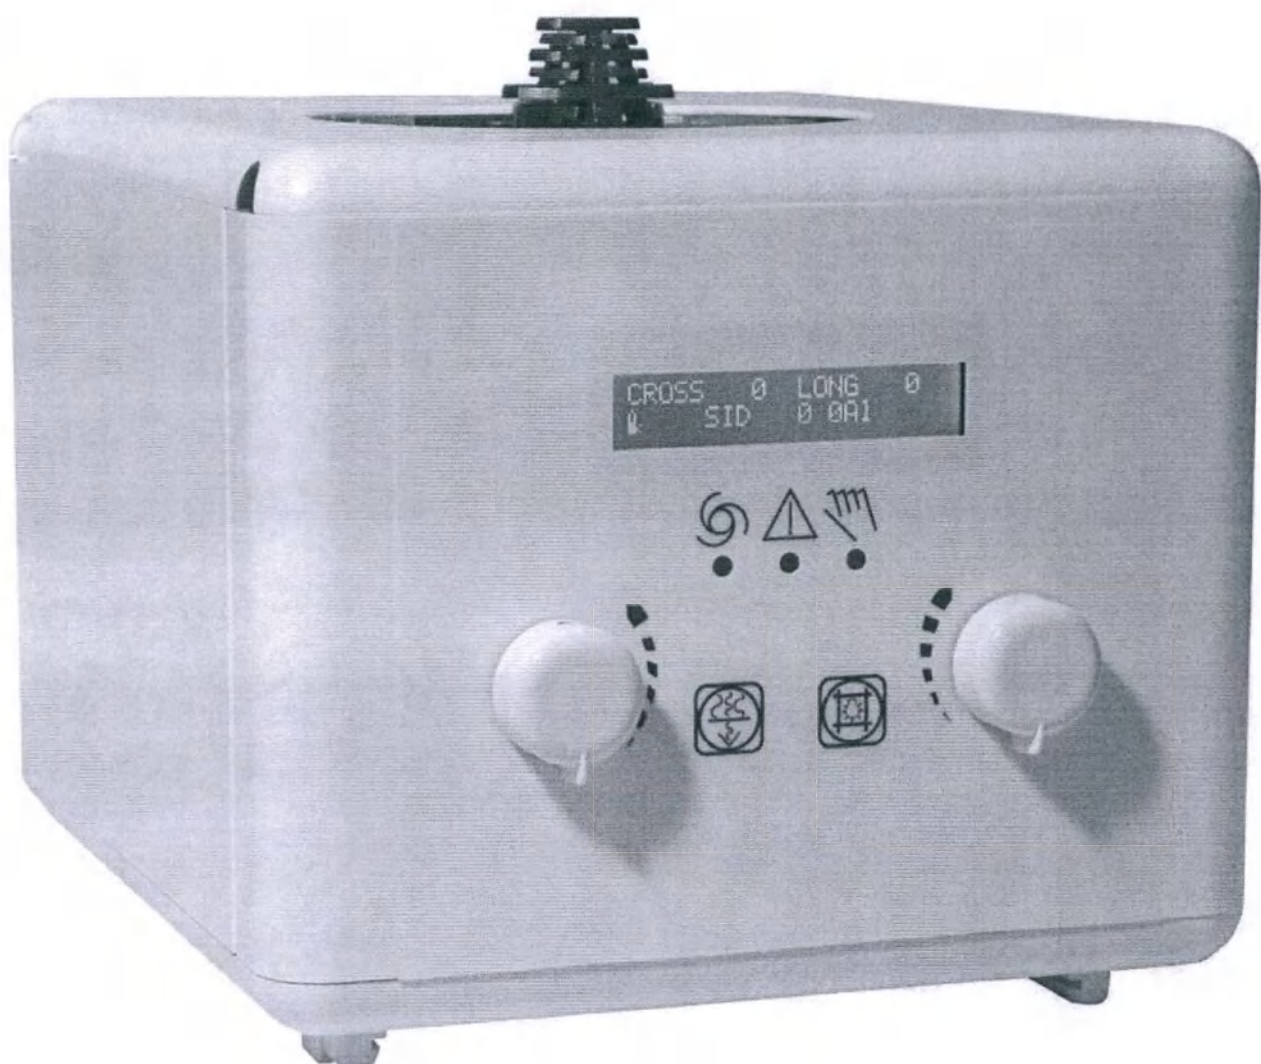


Коллиматор с соединительными элементами, с автоматическим или ручным управлением (может комплектоваться автоматическими или ручными сменными фильтрами) R 225 ACS, производства Ralco srl., Италия

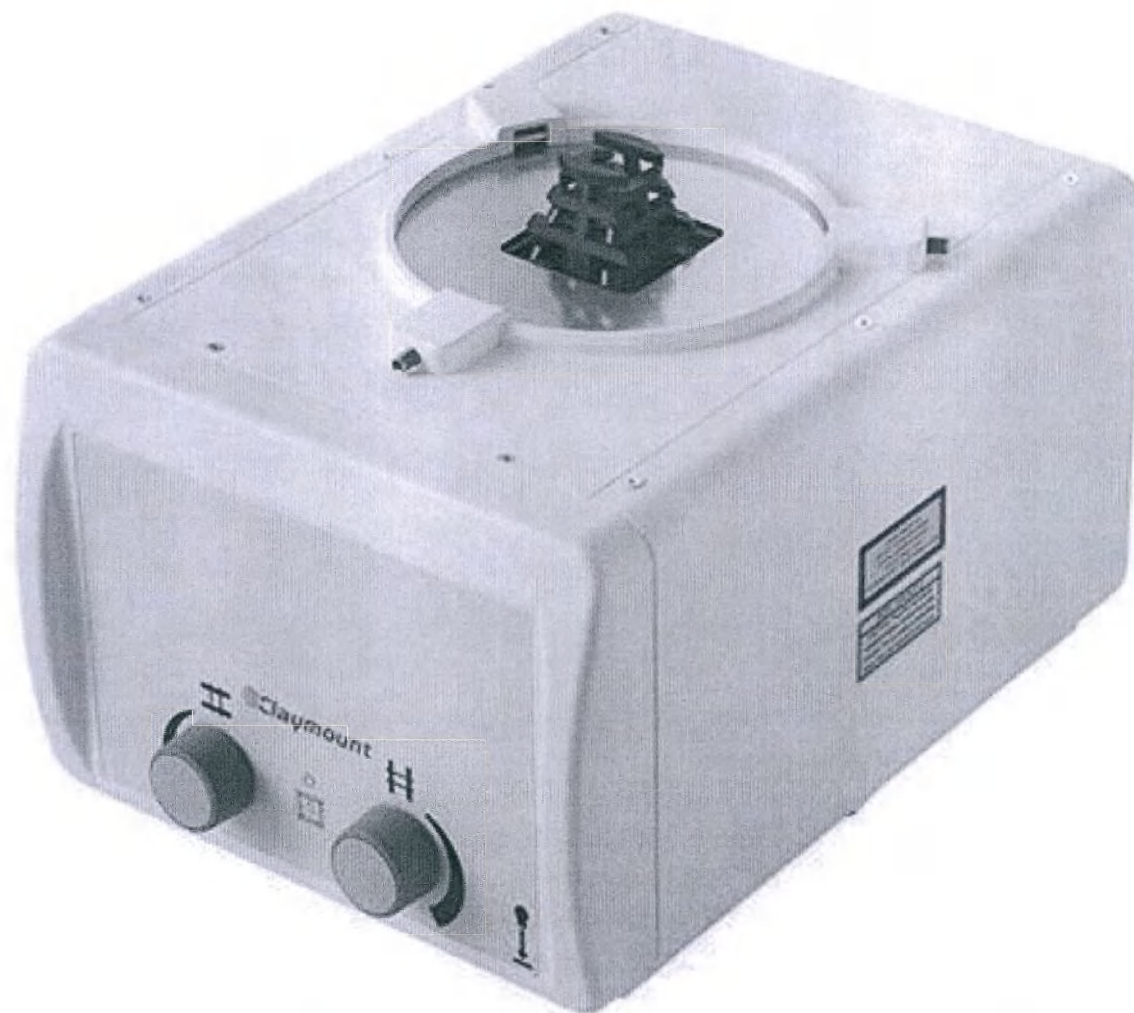

Коллиматор с соединительными элементами, с автоматическим или ручным управлением (может комплектоваться автоматическими или ручными сменными фильтрами) Optica 30, производства Varex Imaging Nederland B.V., Нидерланды или Varex Imaging Corporation, США




Коллиматор с соединительными элементами, с автоматическим или ручным управлением (может комплектоваться автоматическими или ручными сменными фильтрами) Optica 40, производства Varex Imaging Nederland B.V., Нидерланды или Varex Imaging Corporation, США

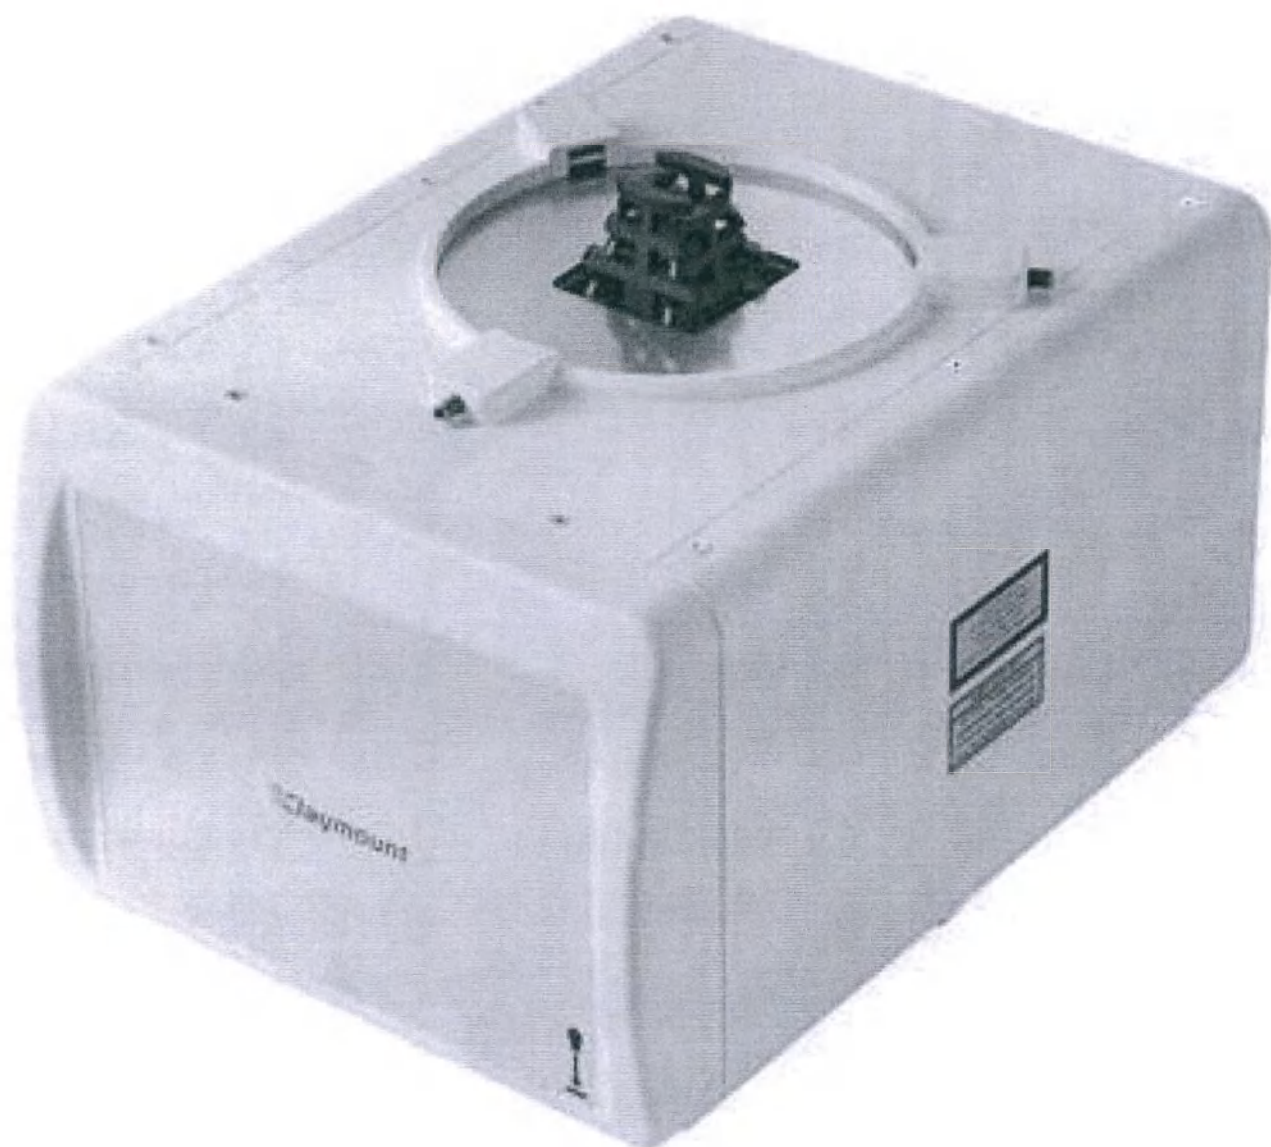


Коллиматор с соединительными элементами, с автоматическим или ручным управлением (может комплектоваться автоматическими или ручными сменными фильтрами) Optica 50, производства Varex Imaging Nederland B.V., Нидерланды или Varex Imaging Corporation, США




Коллиматор с соединительными элементами, с автоматическим или ручным управлением (может комплектоваться автоматическими или ручными сменными фильтрами) AL 02 II eL или AFL 01 II eL, производства Siemens, Германия

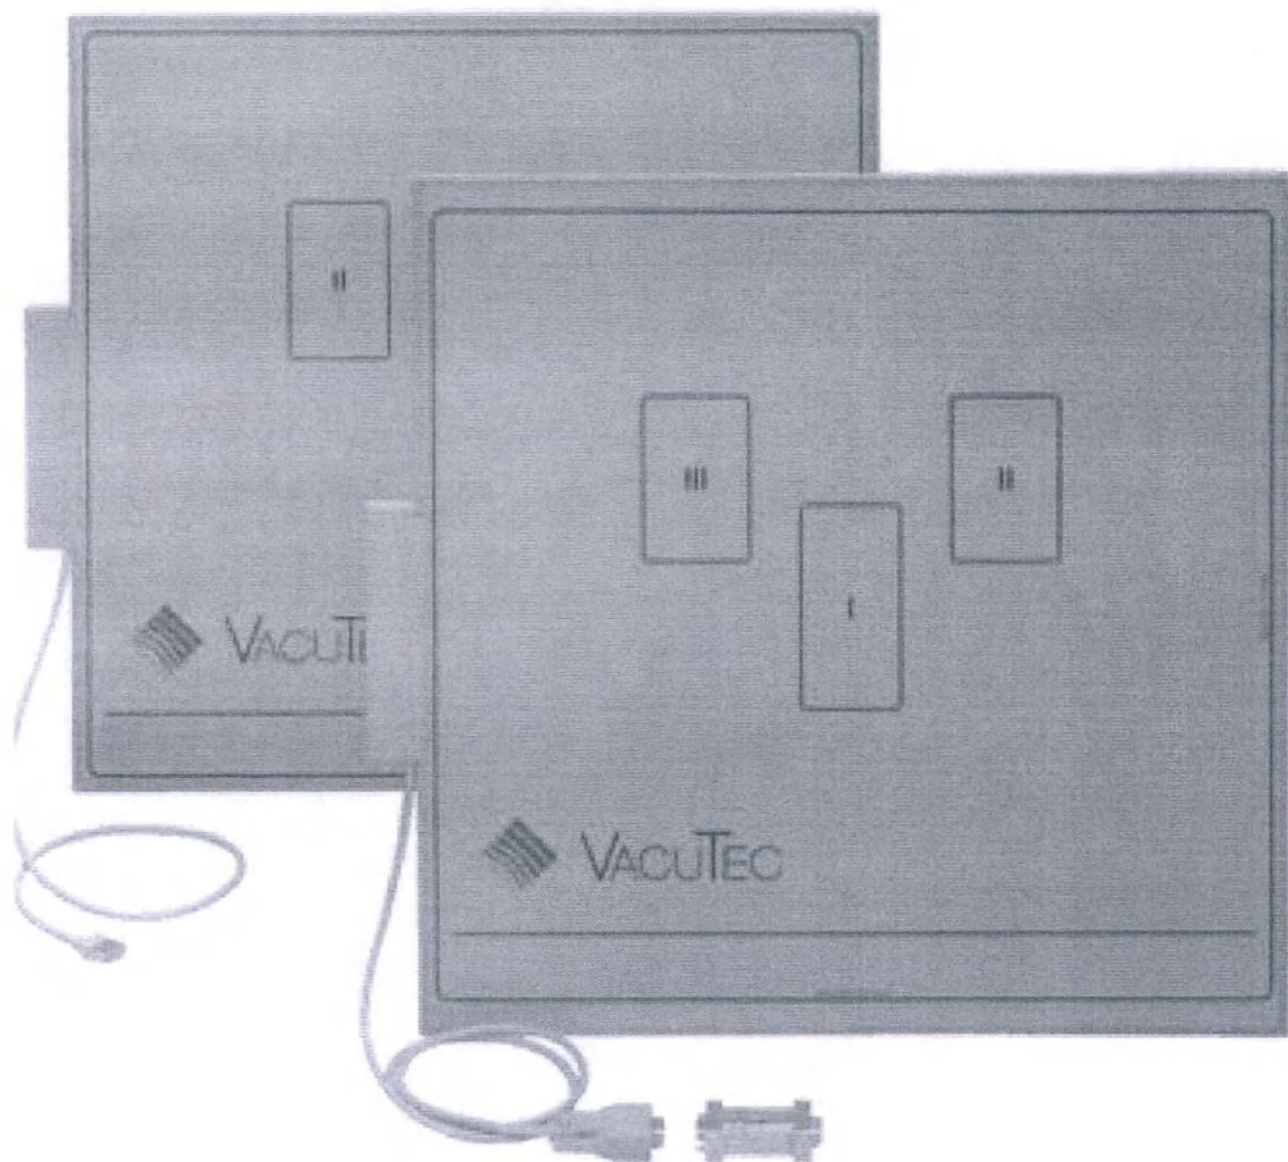


Камера ионизационная серии 70, производства VacuTec, Meßtechnik GmbH, Германия

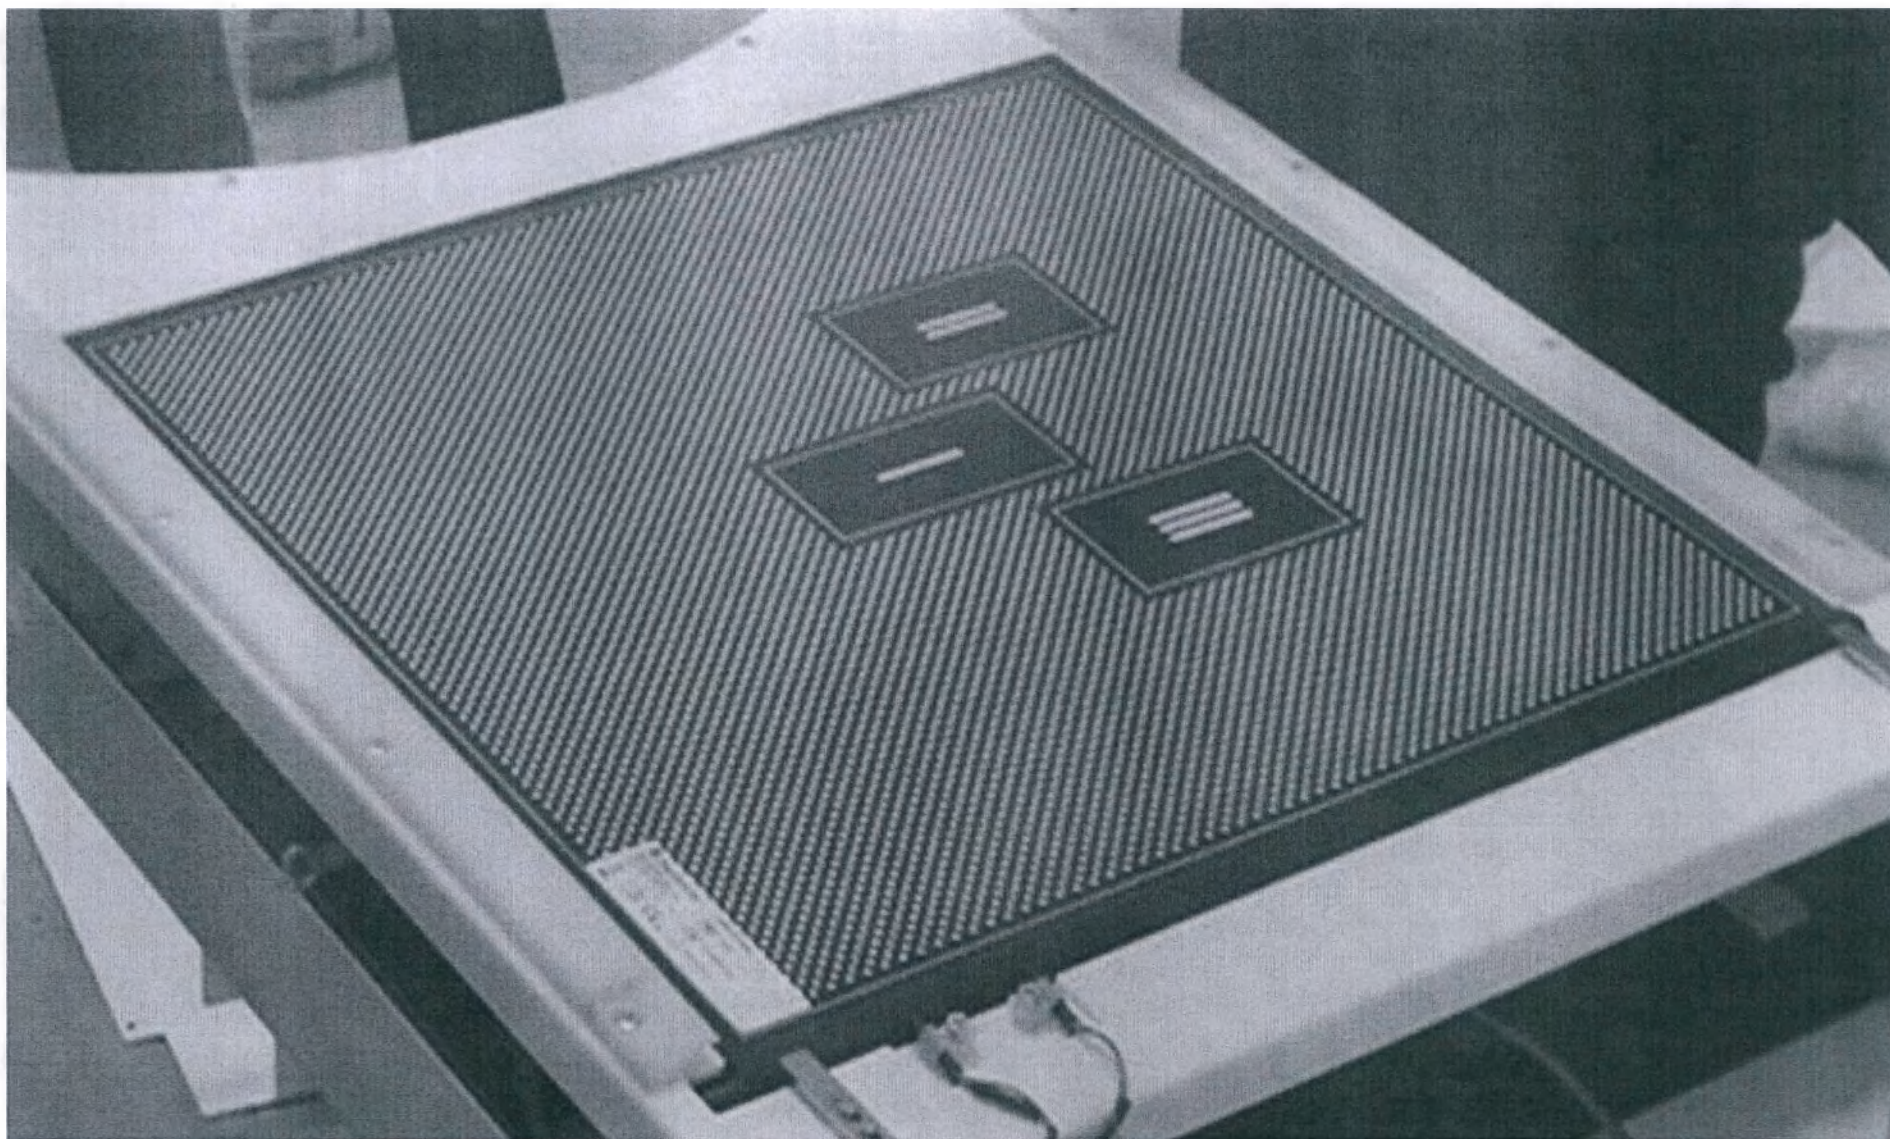

Камера ионизационная серии SSMC, производства Varex Imaging Nederland B.V., Нидерланды или
Varex Imaging Corporation, США или Varex Imaging Corporation, Филиппины

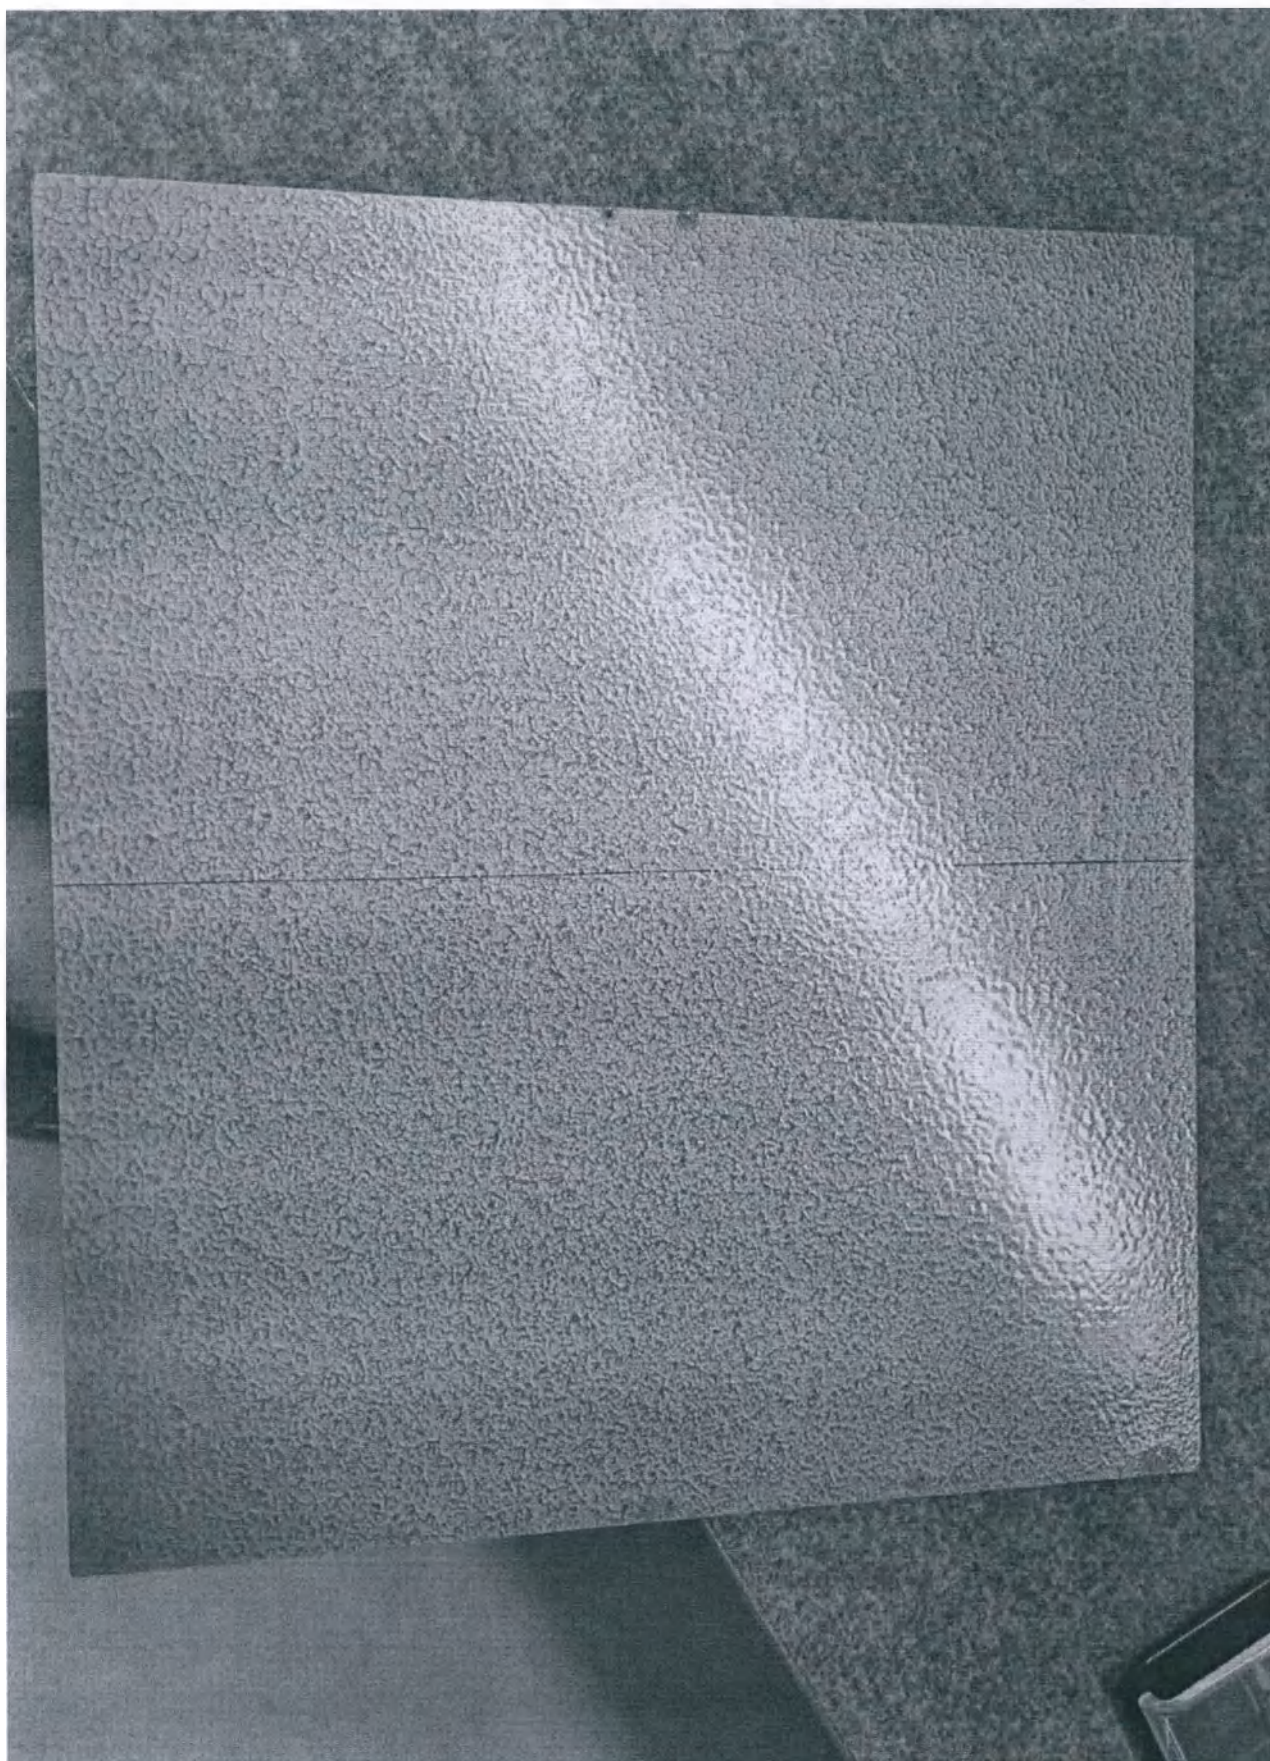


Растр рентгеновский отсеивающий (решетка фокусирующая) серии Lysholm, производства Gridline A.B., Швеция

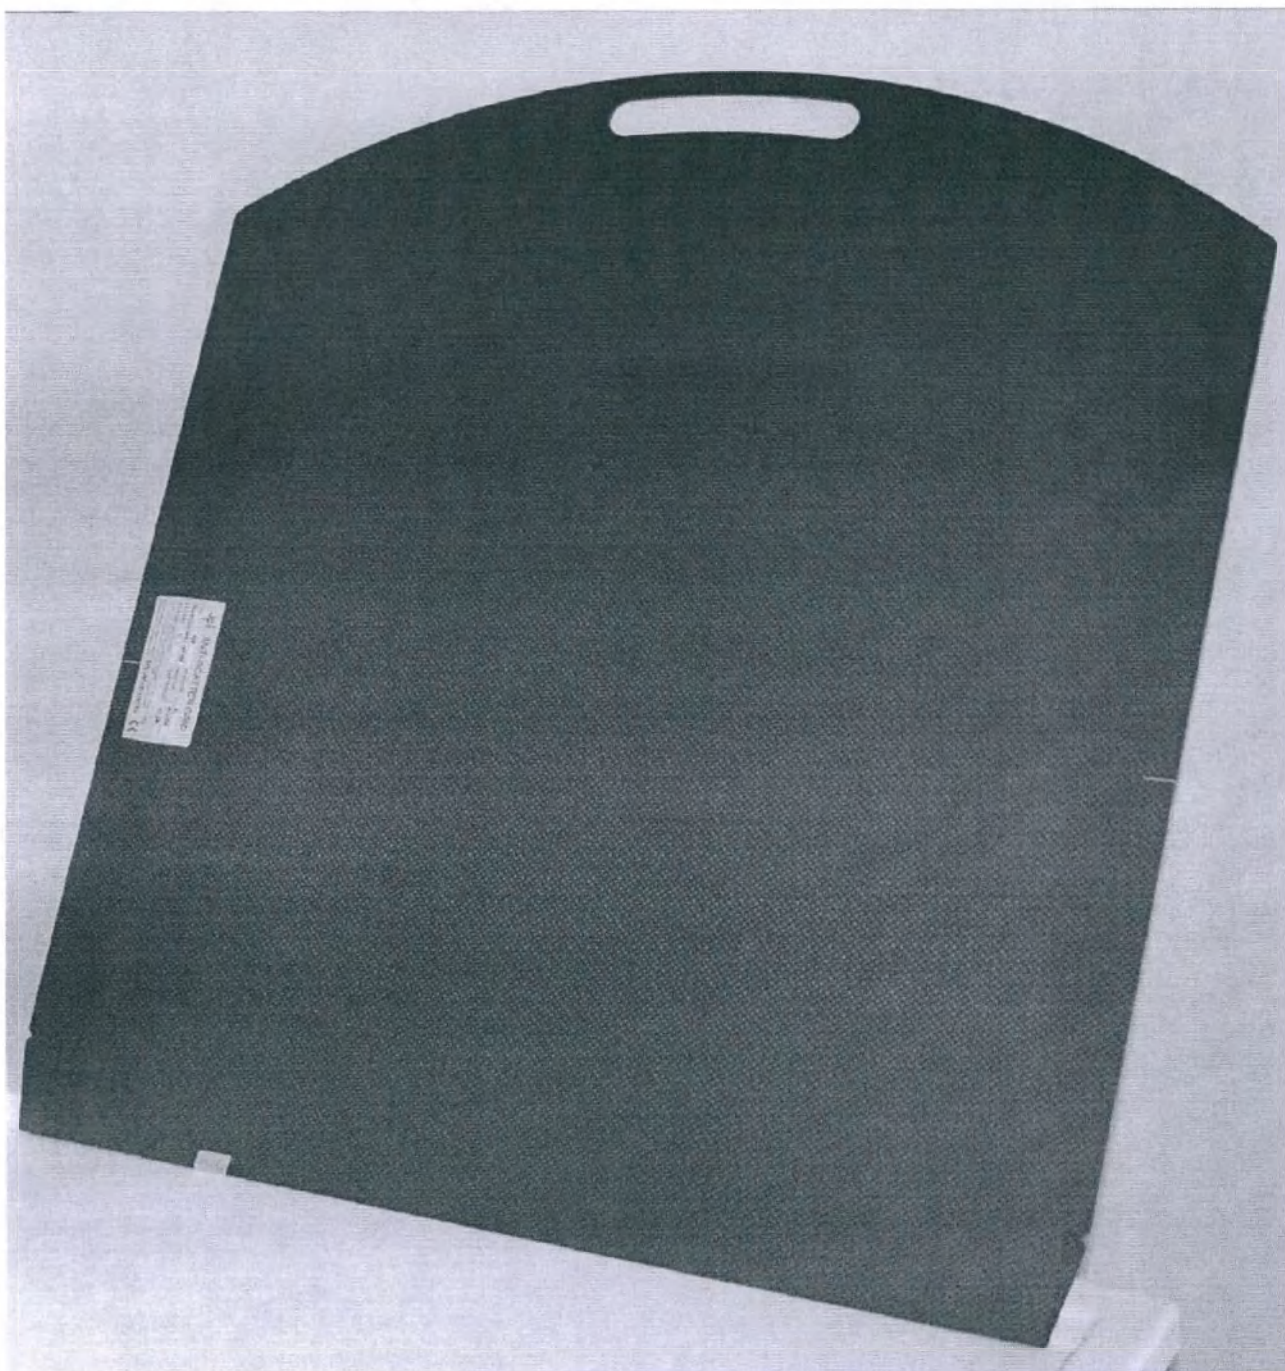


Растр рентгеновский отсеивающий серии JPI производства Jungwon Precision Ind. Co., Ltd, Республика Корея




Двойная педаль включения экспозиции, производства Herga Technology Ltd., Великобритания

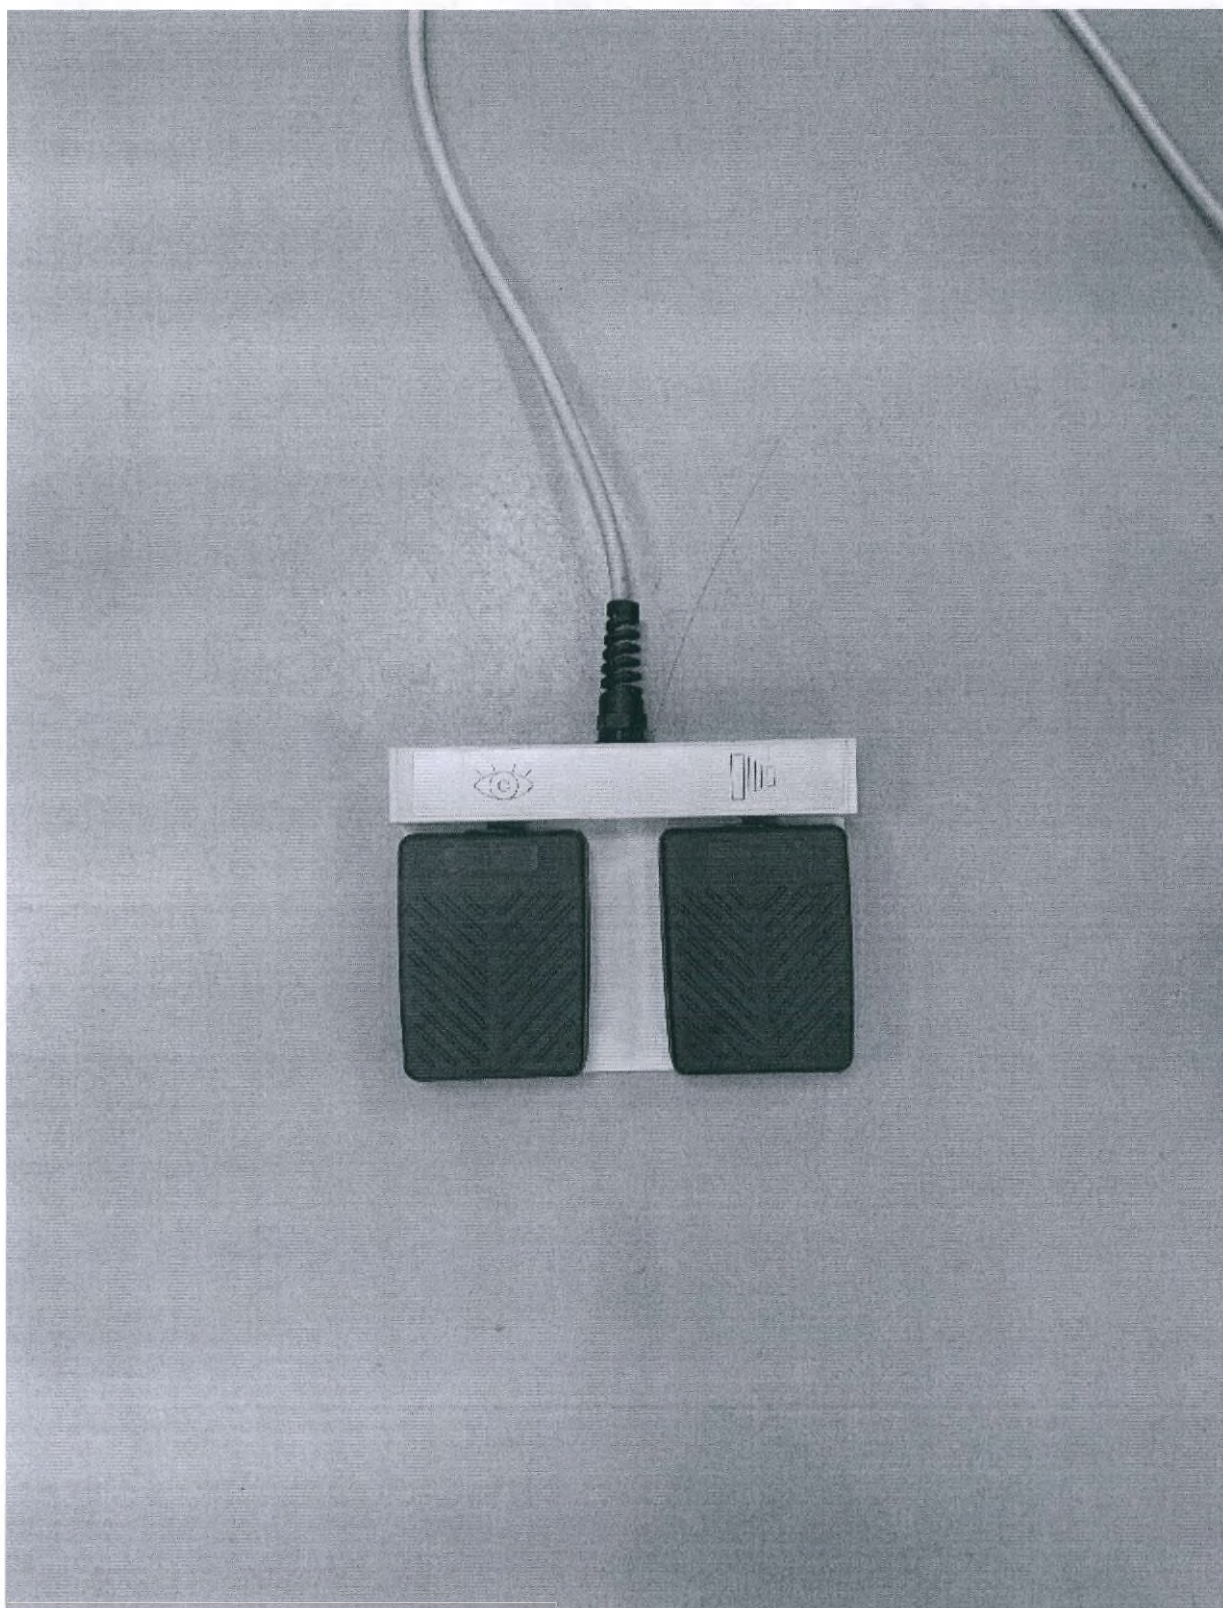

Педаль включения рентгеновского излучения в проводном или беспроводном исполнении, производства SUNS International, LLC, США (Китай)

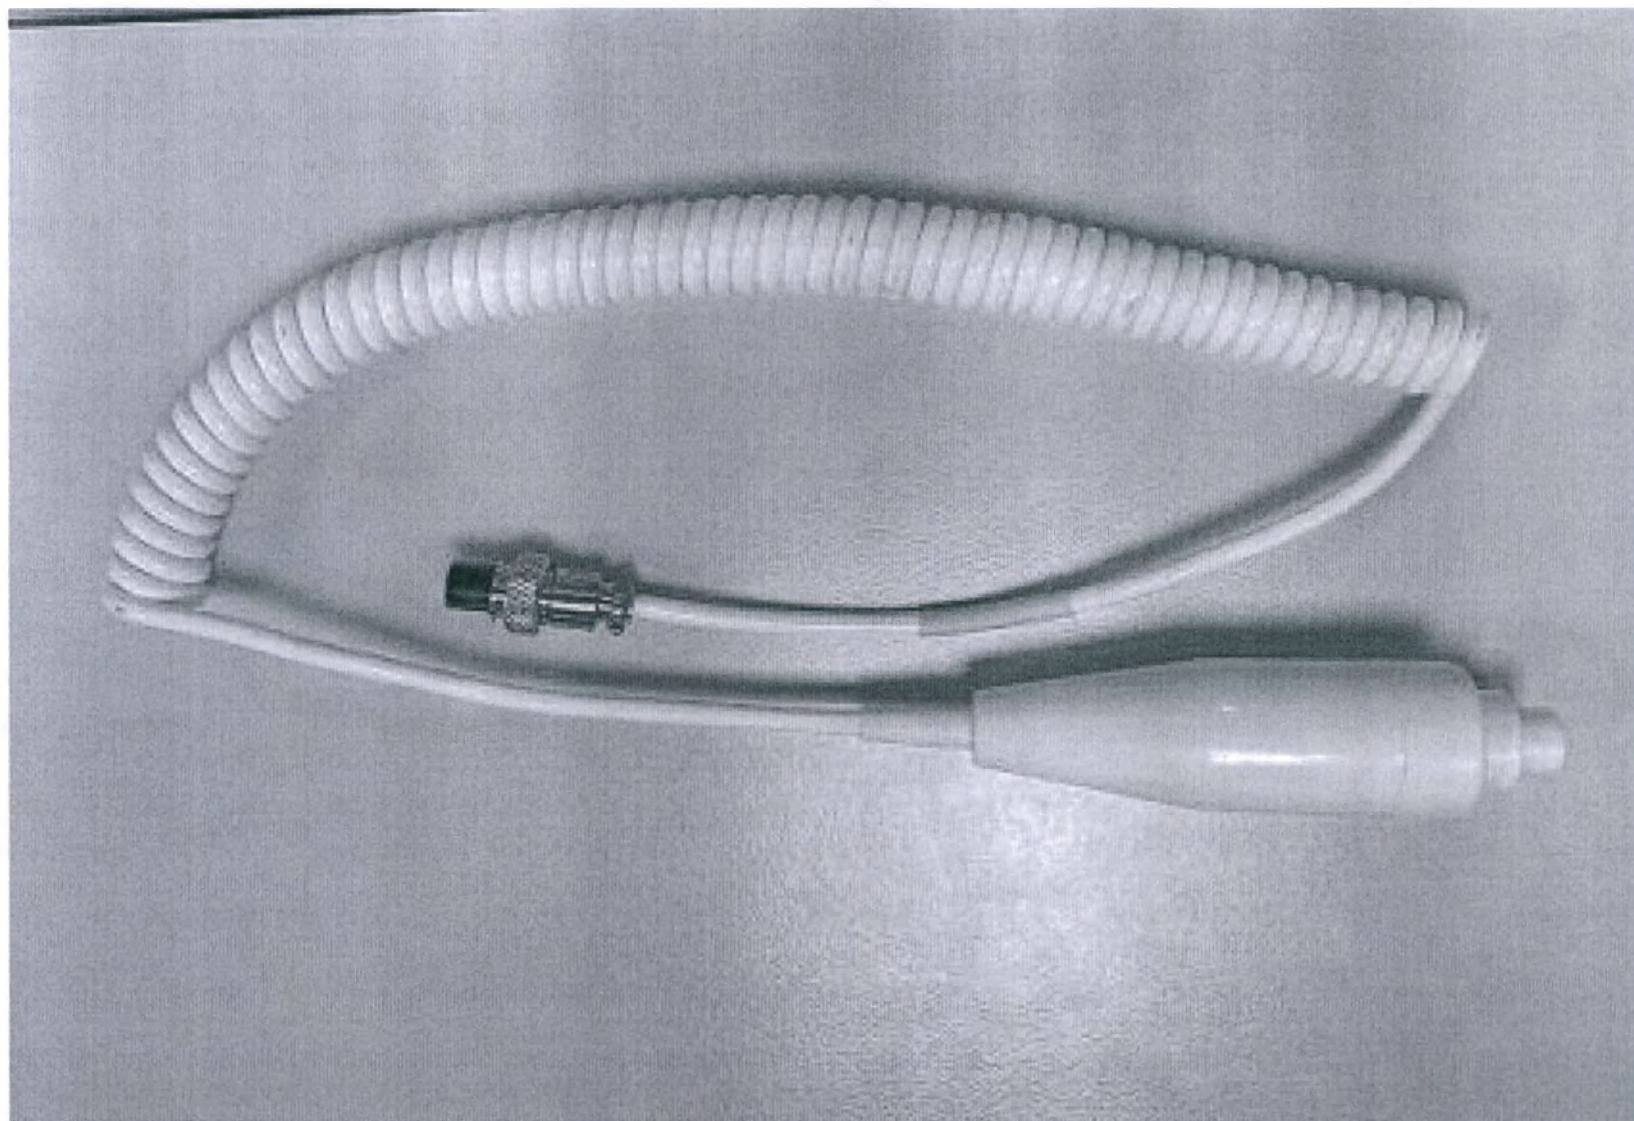


Устройство включения экспозиции 2,2 м и/или 5 м, производства Dongzi Medical System Co., Китай

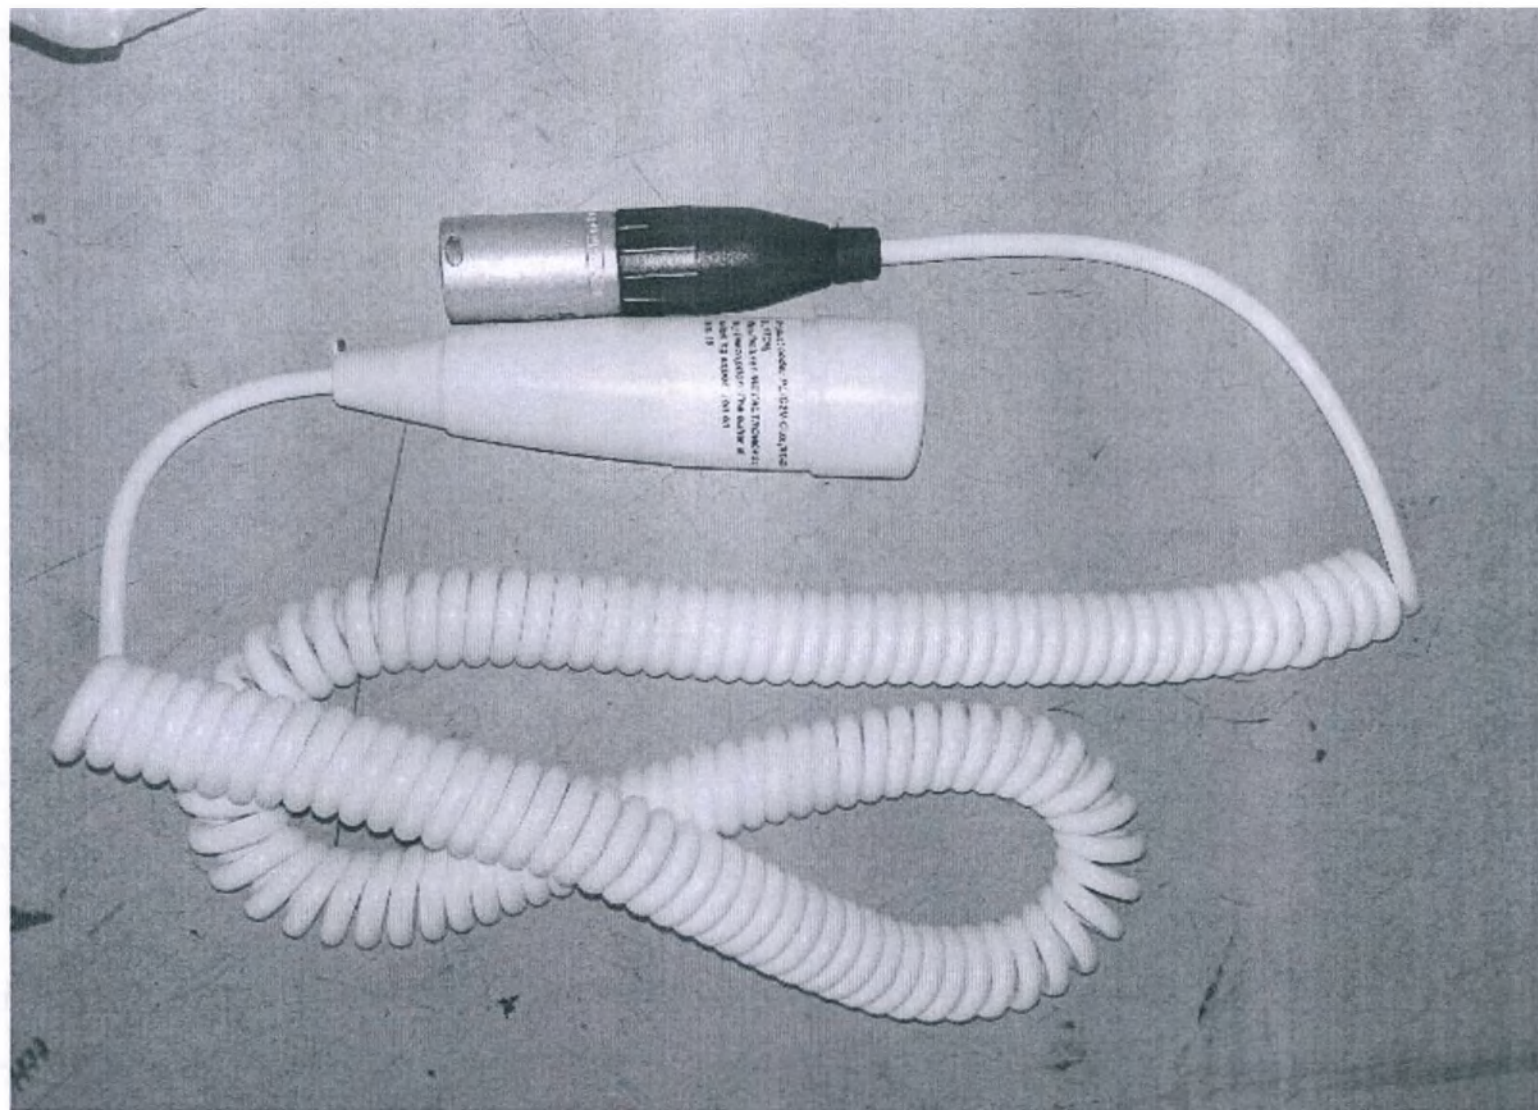


Устройство включения экспозиции 2,2 м и/или 5 м, производства OMRON Corporation, Япония



Монитор ЖК с диагональю от 19 до 32 дюймов Tecnint,
производства Tecnint HTE s.r.l., Италия

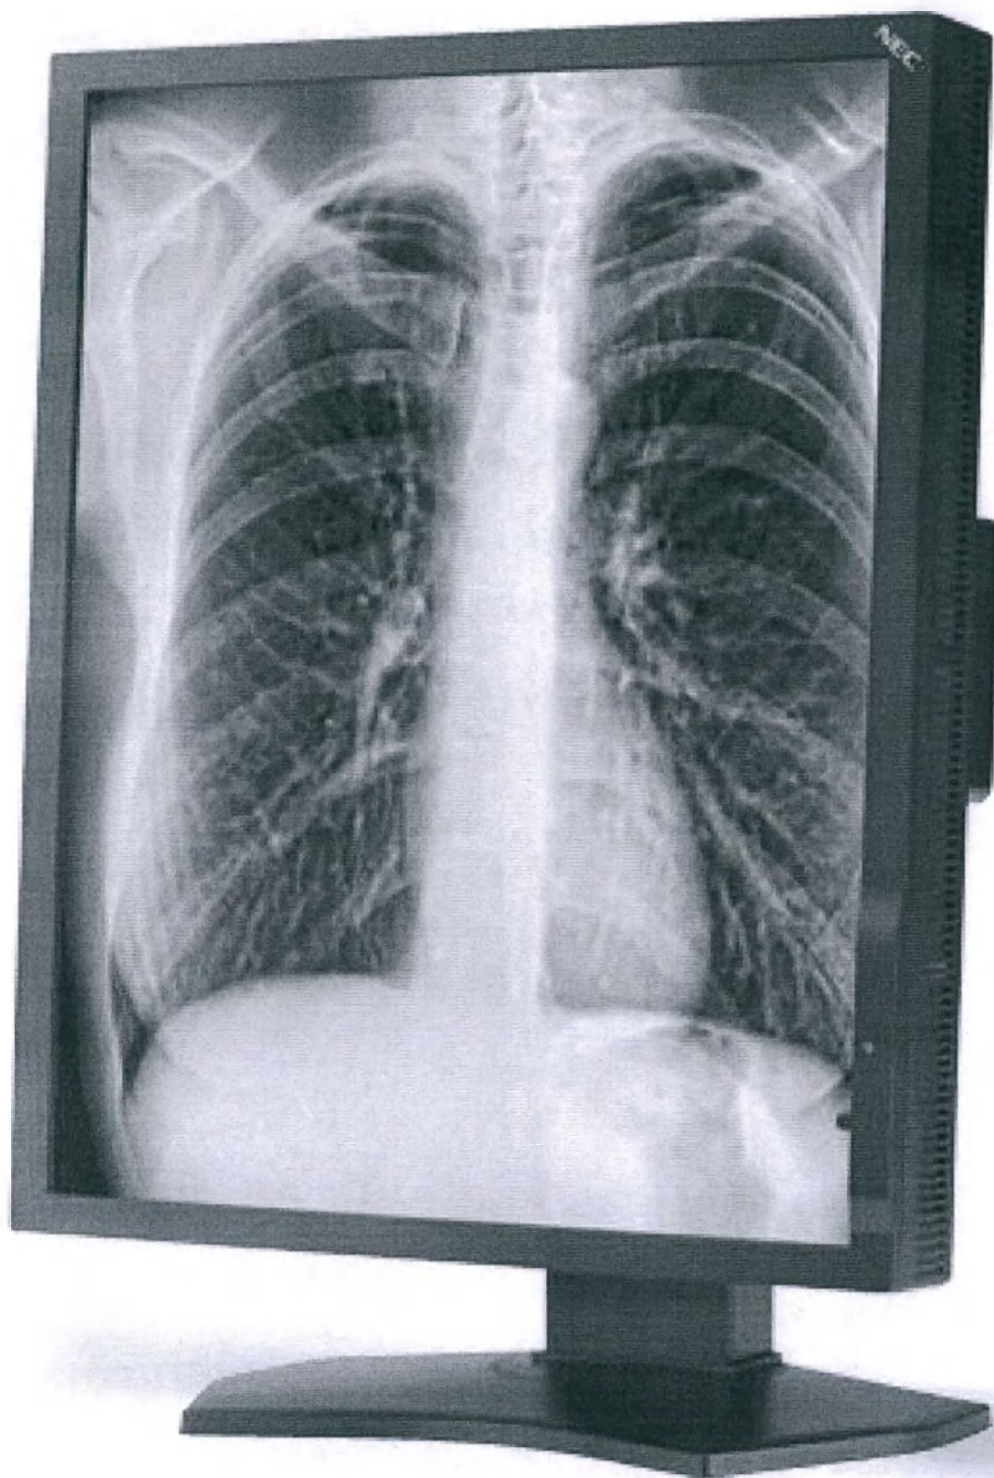


Монитор ЖК с диагональю от 19 до 32 дюймов NEC, производства NEC Display Solutions Ltd, Япония или Compal Electronics (China) Co., Ltd, Китай или Compal Display Electronics (Kunshan) Co., Ltd, Китай

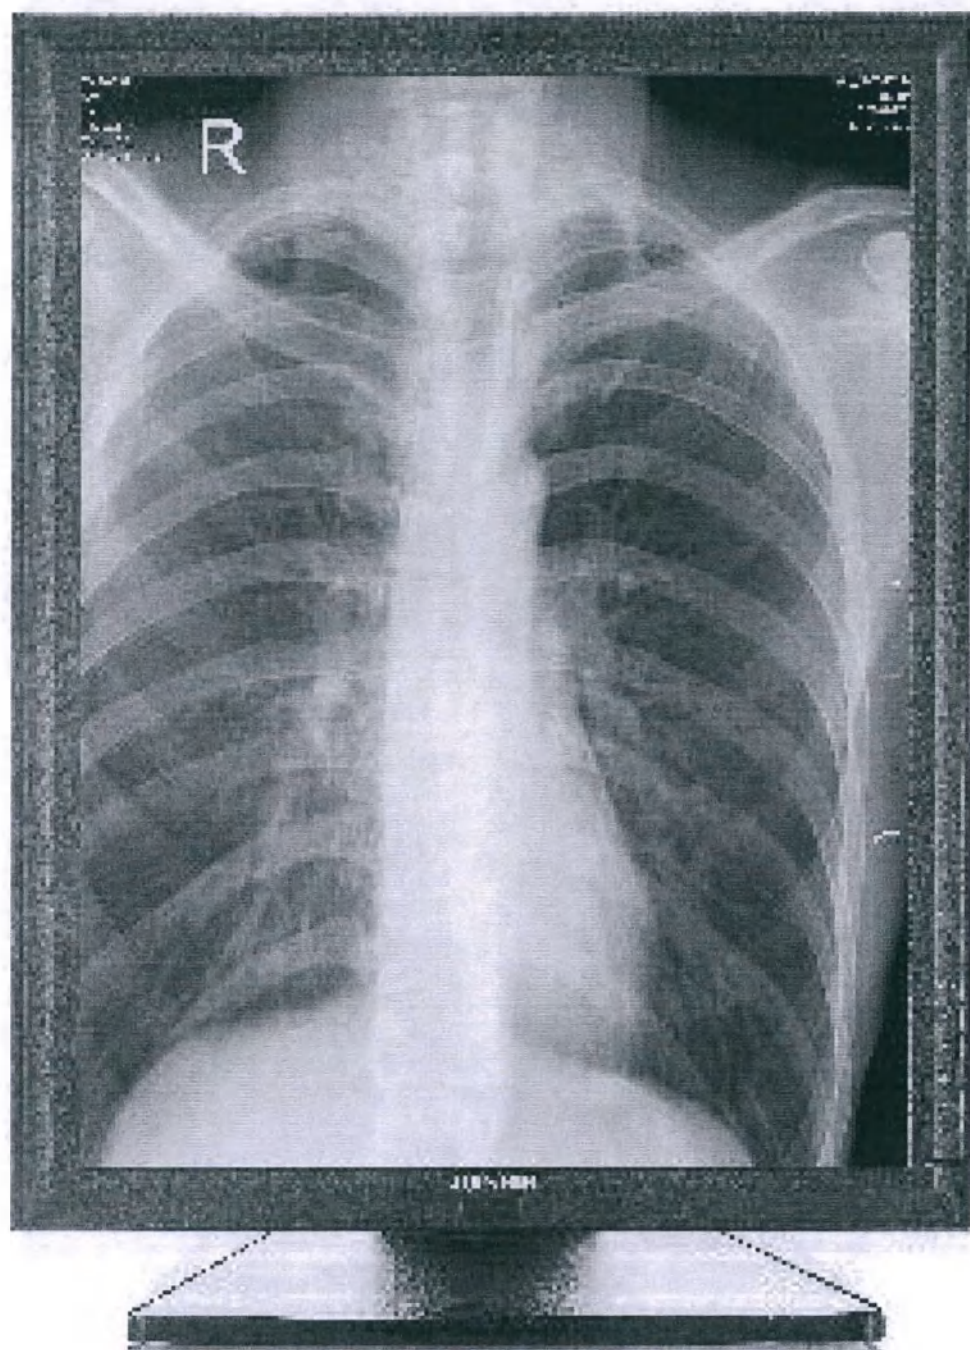


Монитор ЖК с диагональю от 19 до 32 дюймов Jusha, производства Nanjing Jusha Display Technology Co., Ltd, Китай




Монитор ЖК с диагональю от 19 до 32 дюймов HP, производства Hewlett-Packard Co., США или Wistron Corporation, Тайвань или Wistron Mexico S.A. de C.V, Мексика или Wistron InfoComm (Zhongshan) Corporation, Китай или All Technology (Zhongshan) Co. Ltd, Китай или Wistron InfoComm (Czech) s.r.o., Чешская Республика (на фото изображен монитор ЖК с диагональю 24 дюйма серии Z, производства Hewlett-Packard Co., США)

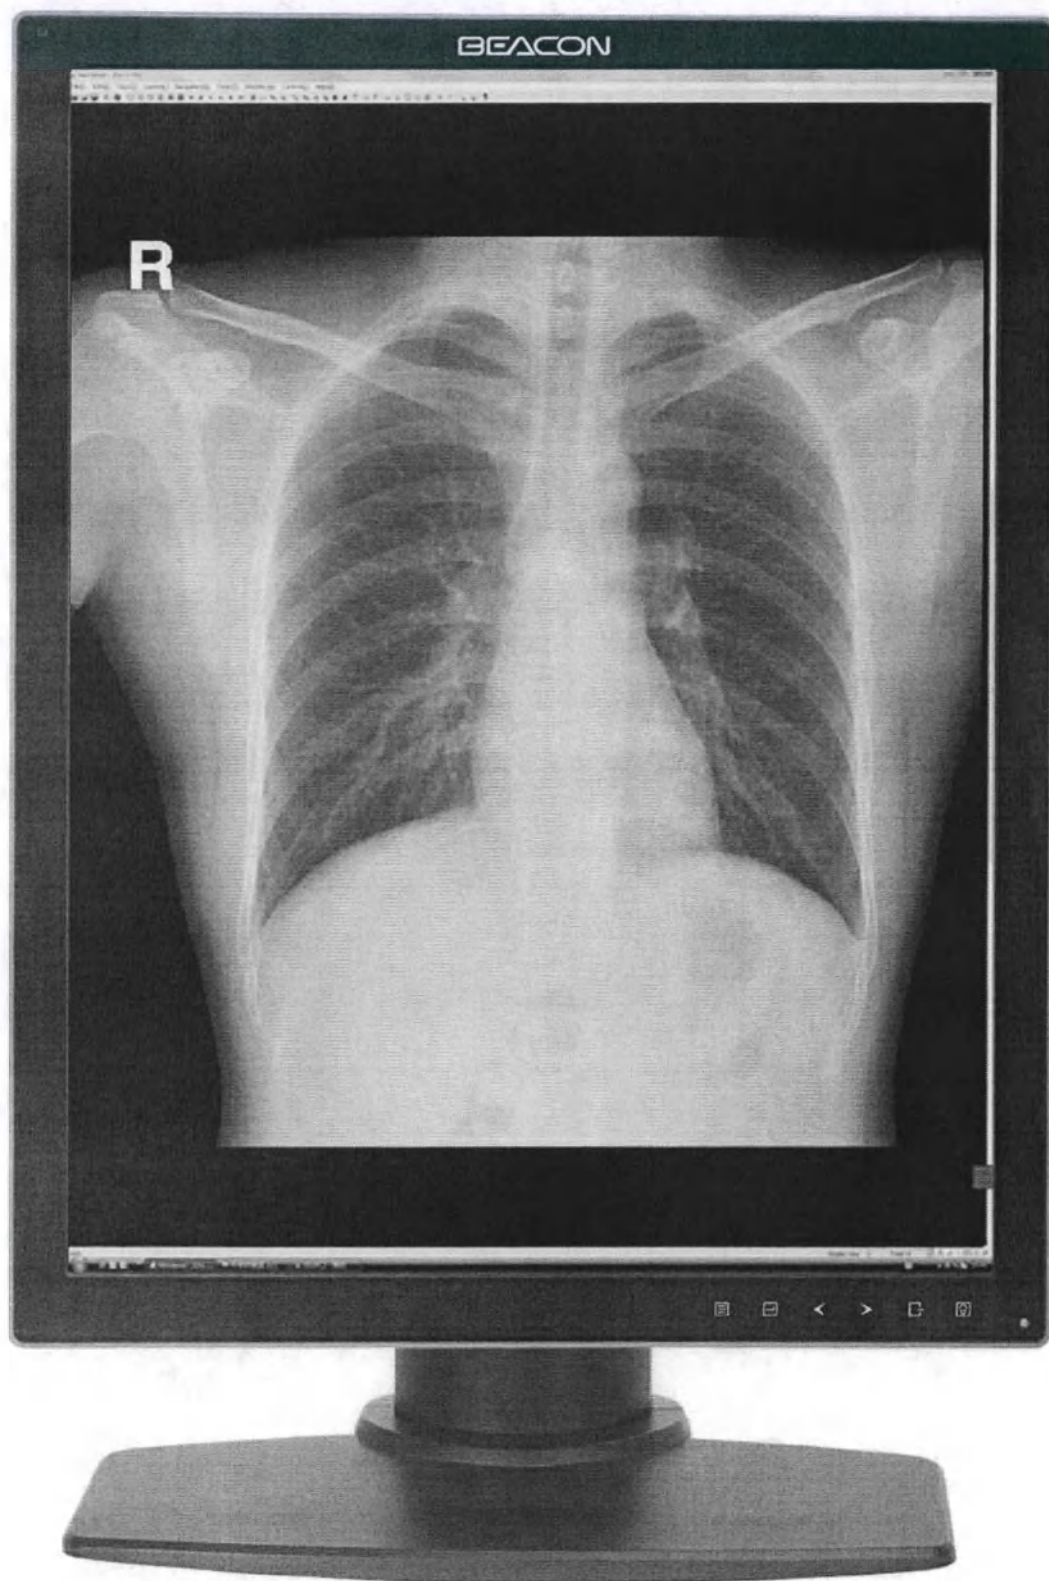


Монитор ЖК с диагональю от 19 до 32 дюймов Beacon,
производства Shenzhen Beacon Display Technology Co., Ltd, Китай

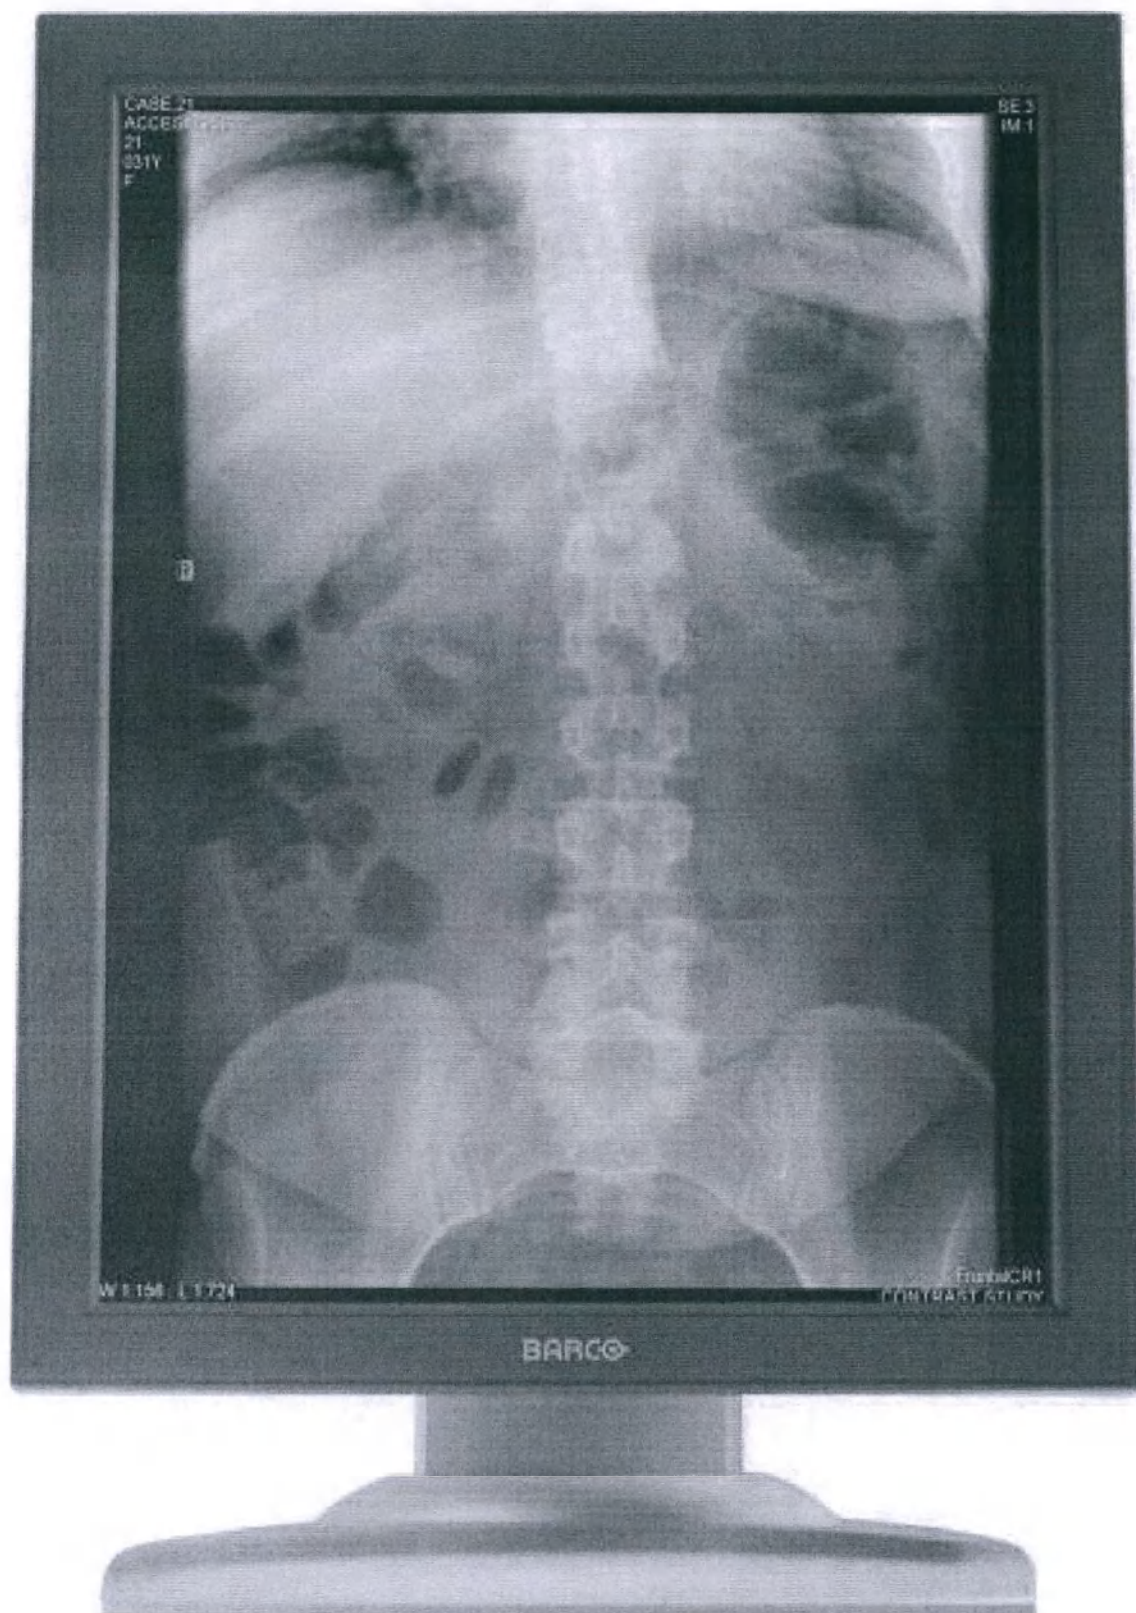


Монитор ЖК с диагональю от 19 до 32 дюймов Barco, производства Barco N.V., Бельгия

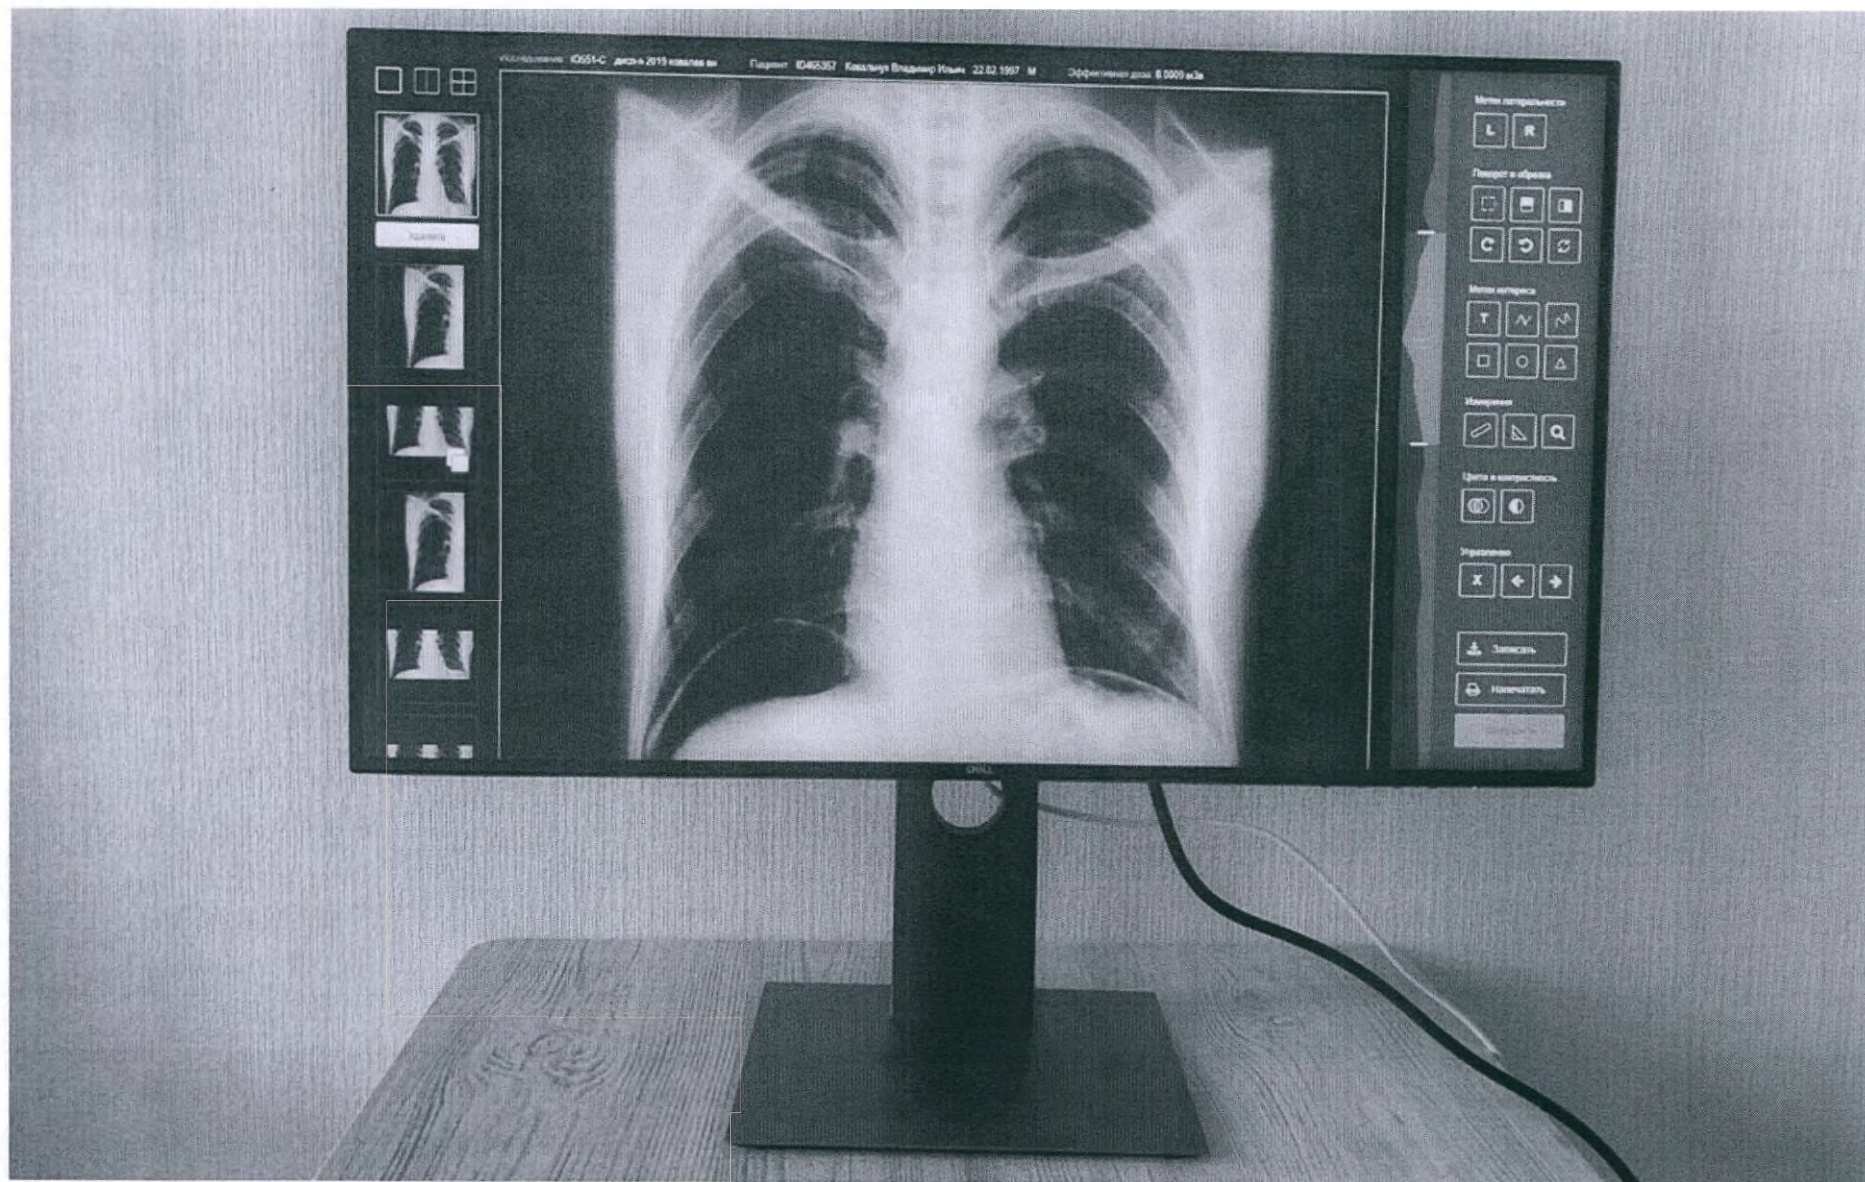


Монитор ЖК с диагональю от 19 до 32 дюймов DELL, производства DELL, Китай

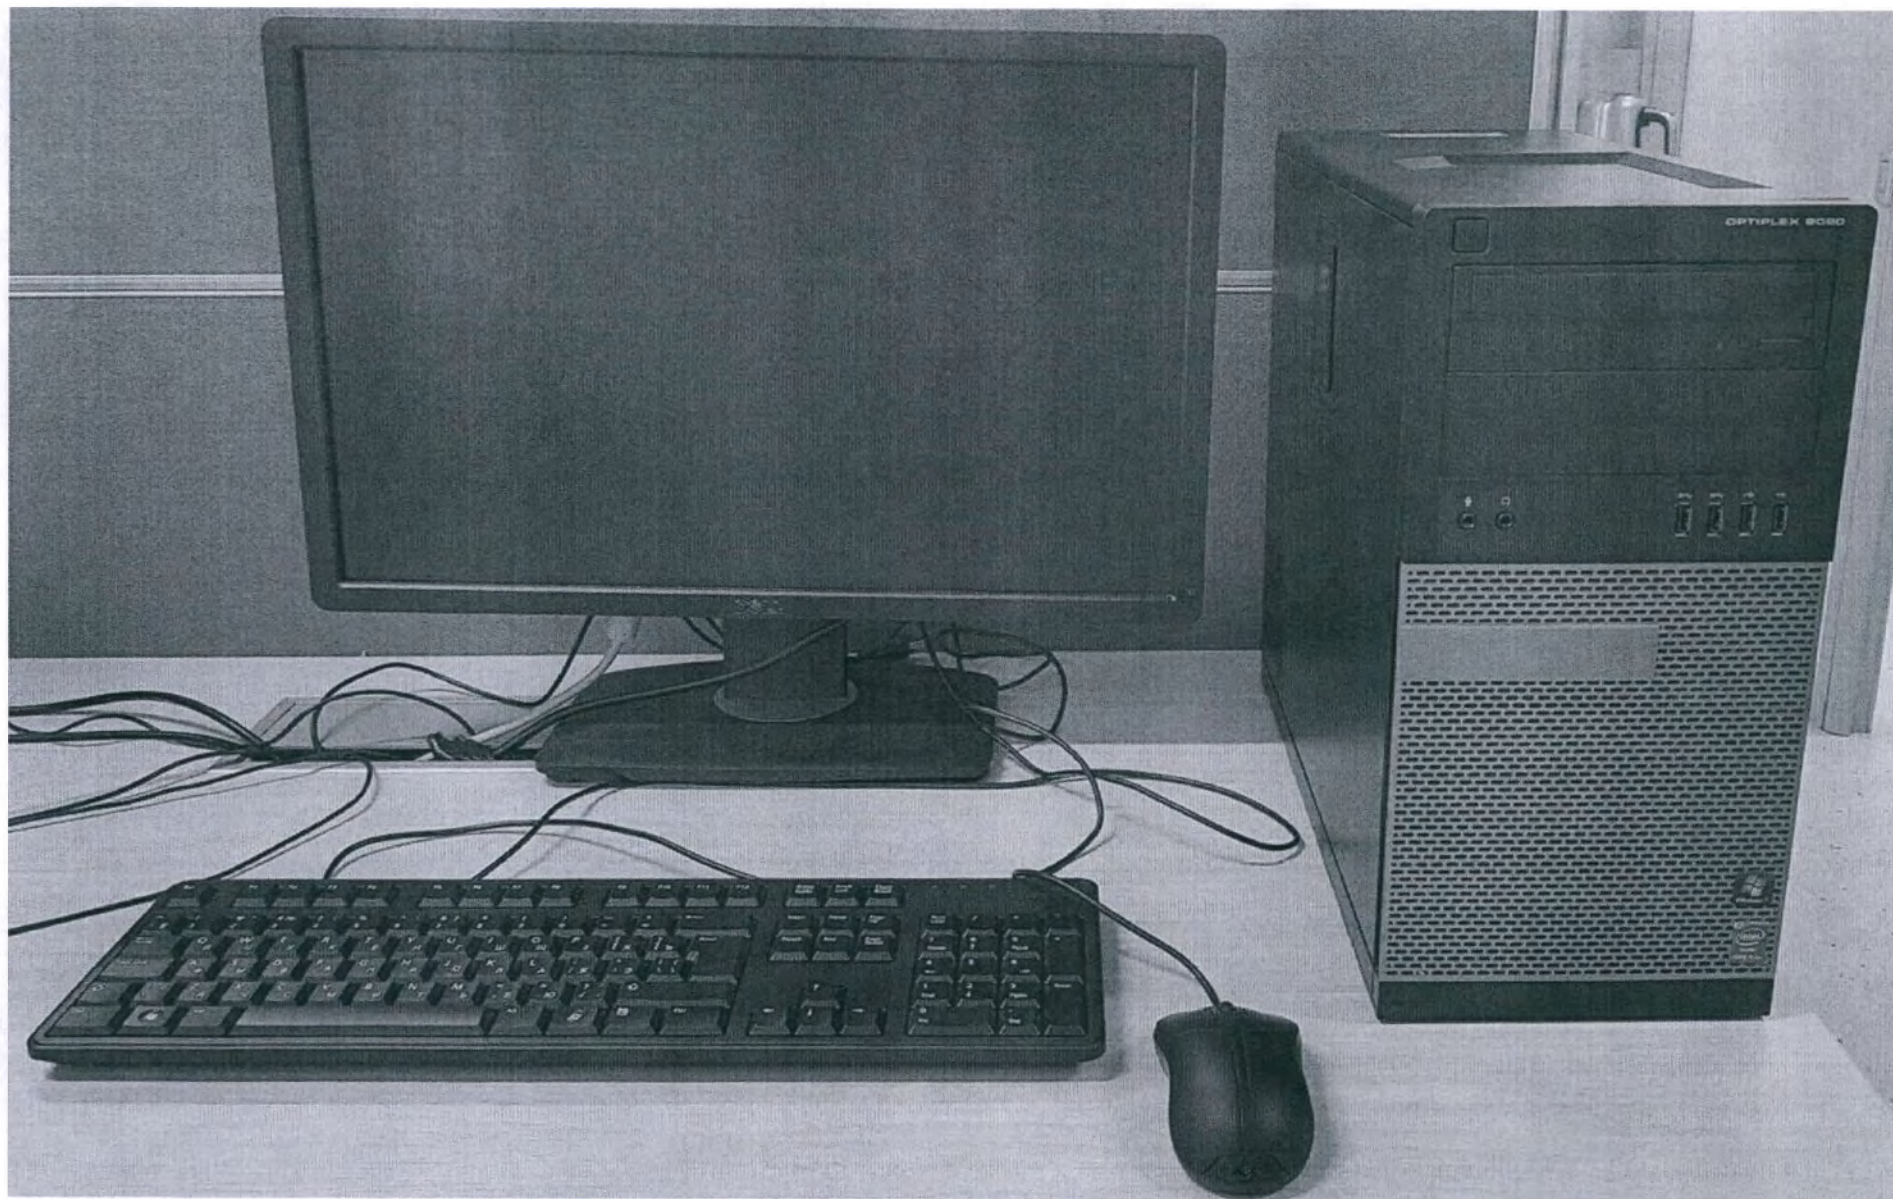


Автоматизированное рабочее место врача-рентгенолога «ДИАРМ-МТ-Плюс», производства АО «МТЛ», Россия

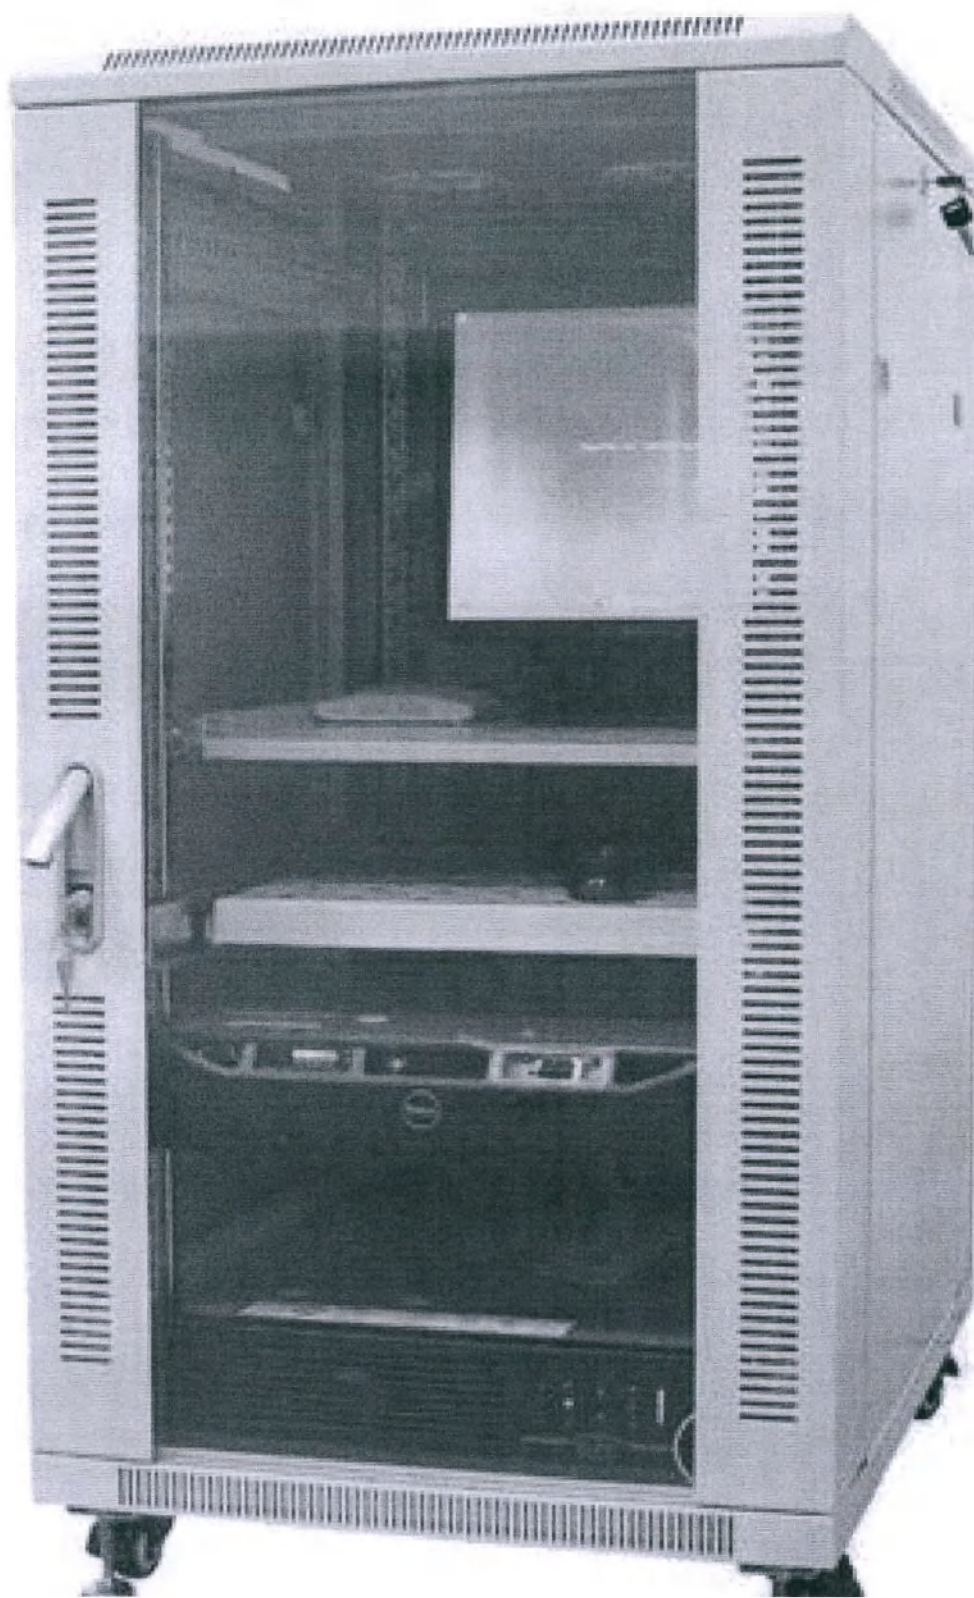

Радиологическая информационная система «ИнтеГРИС-МТ-Плюс»,
производства АО «МТЛ», Россия

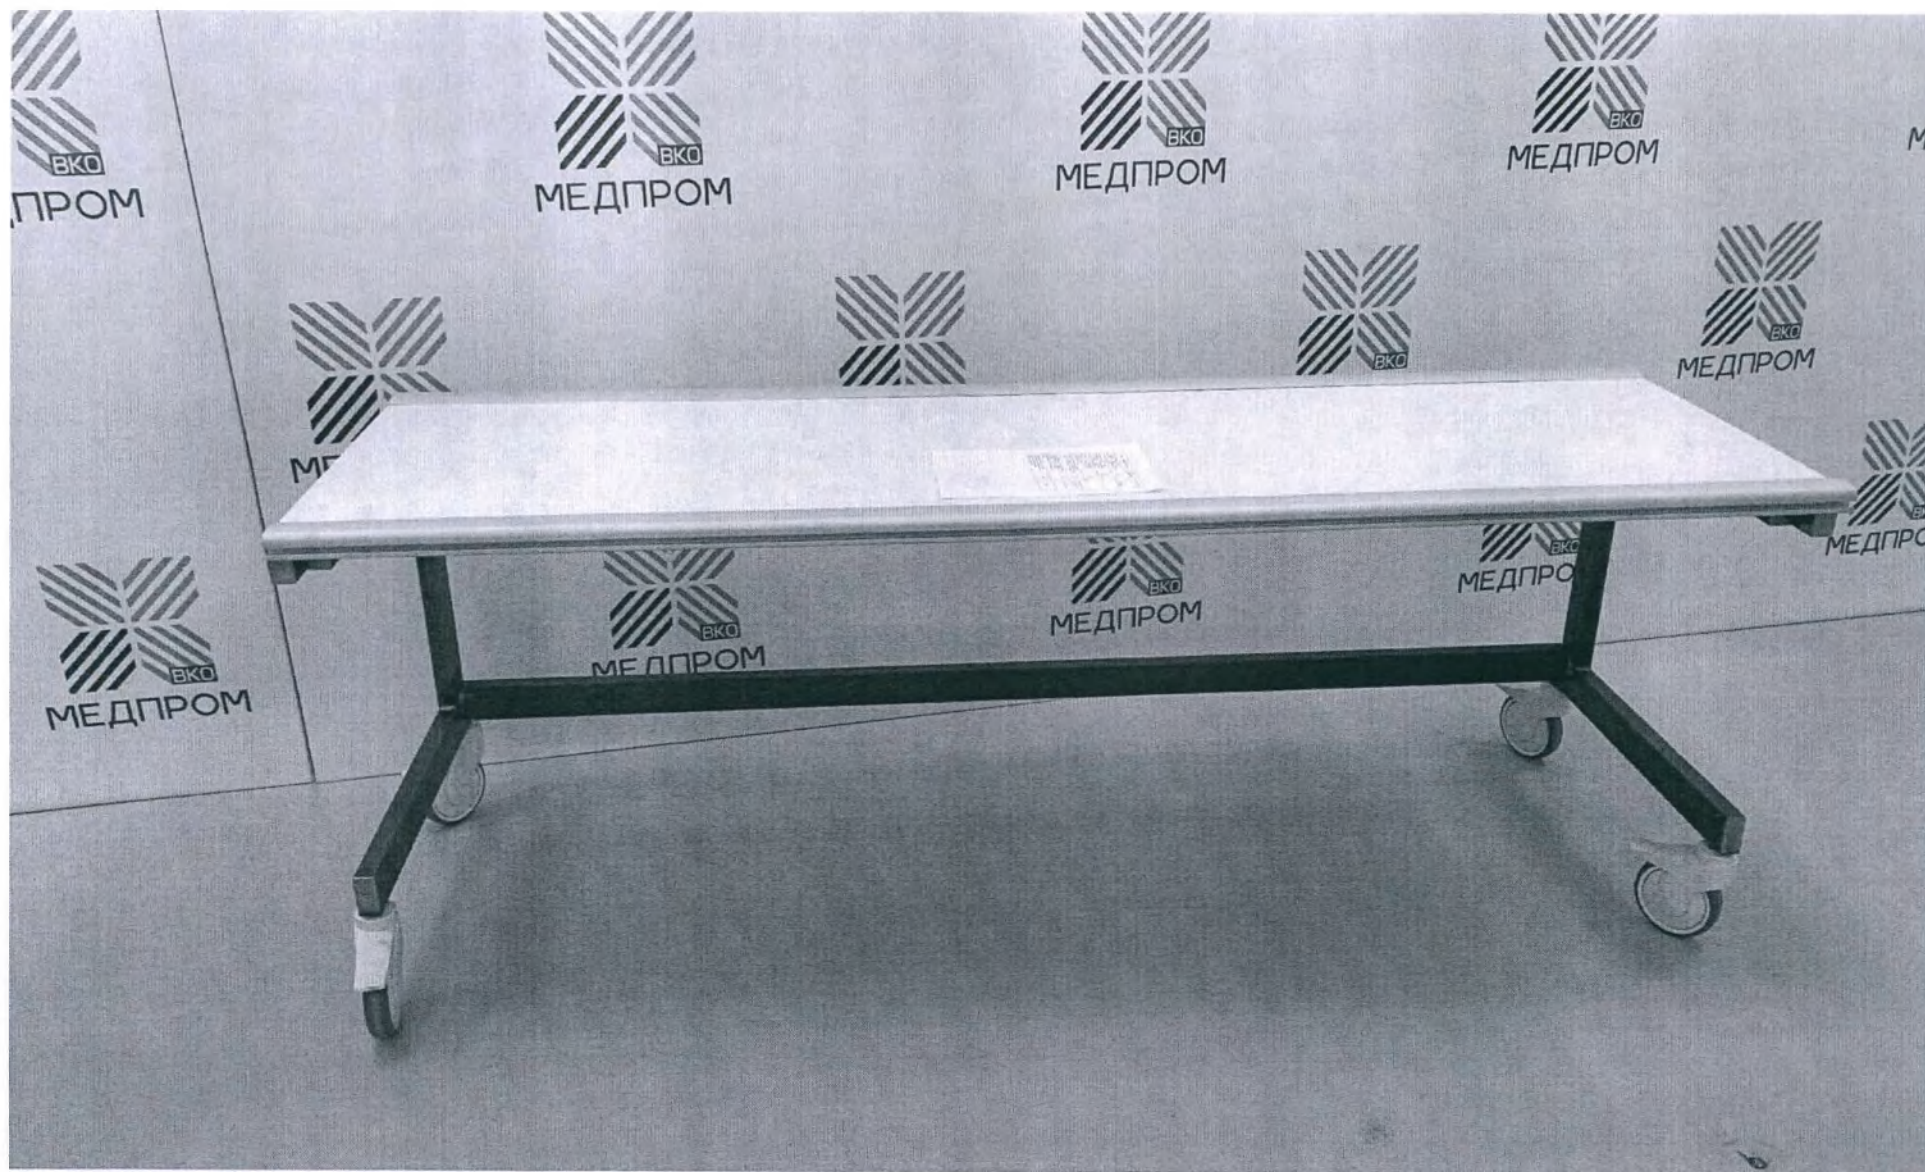

Стол пациента передвижной Y1-B0100, производства ООО «ВКО Медпром», Россия

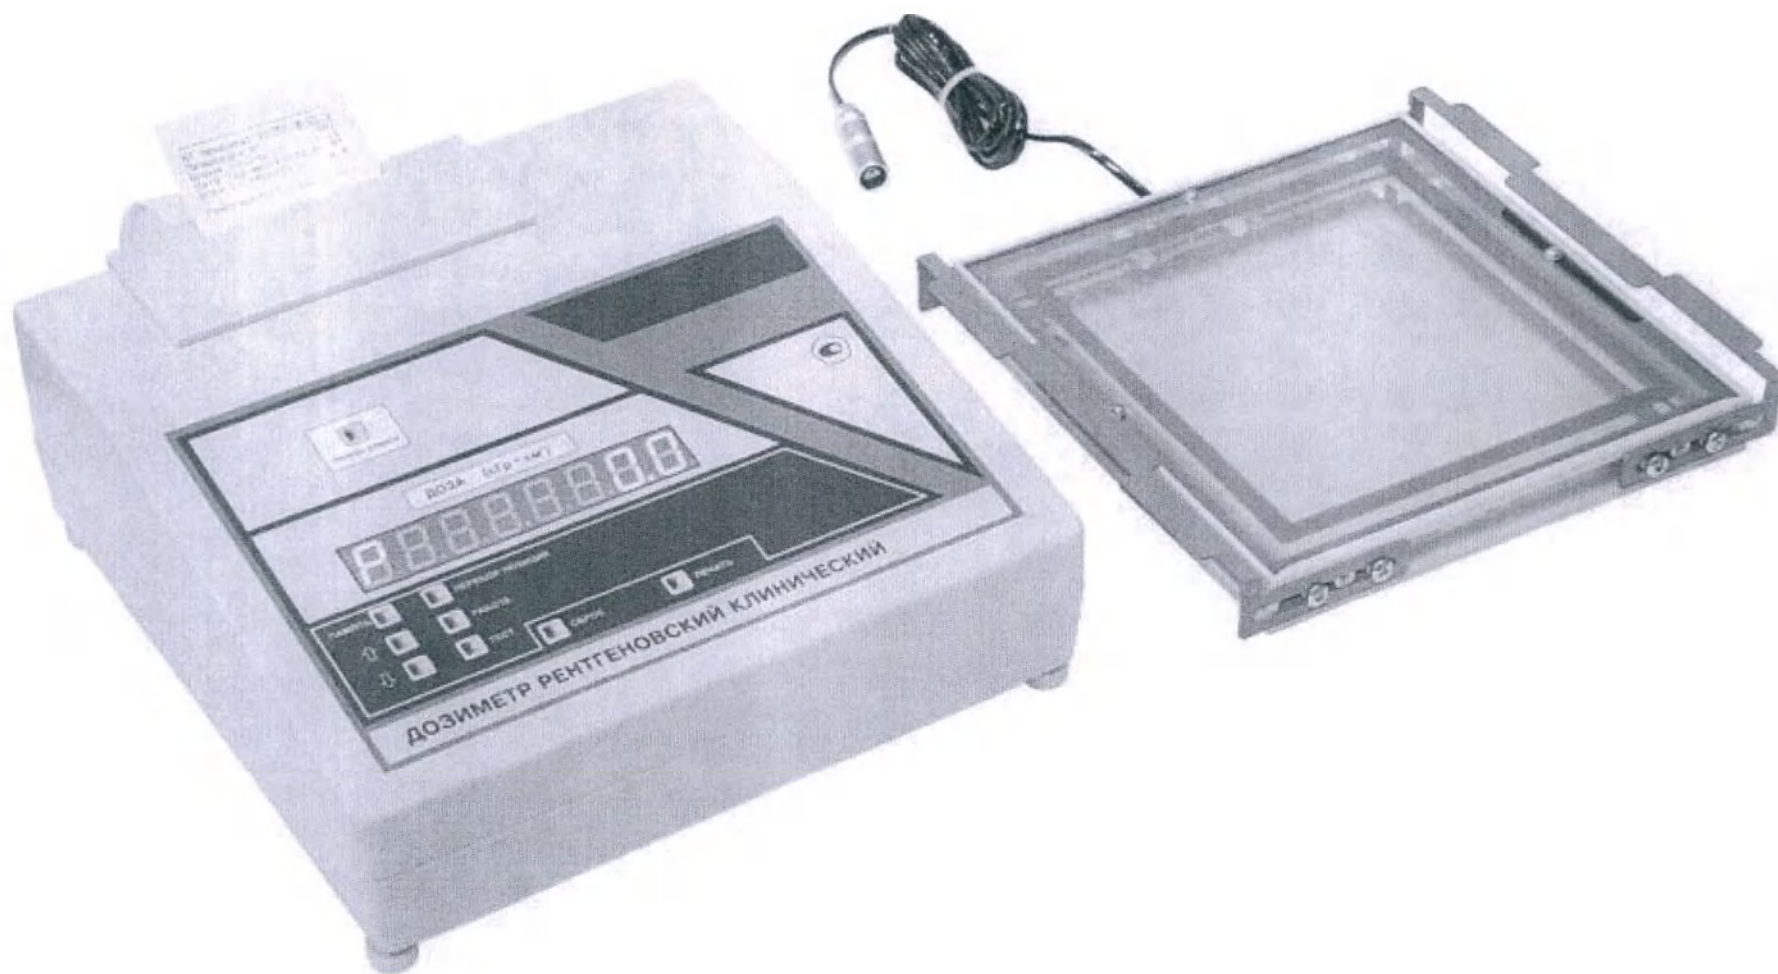

Дозиметры рентгеновского излучения клинические ДРК по ТУ 9441-109-31867313-2012 ДРК-1,
производства ООО НПП «Доза». Россия




Дозиметры рентгеновского излучения клинические ДРК по ТУ 9441-109-31867313-2012 ДРК-1М, производства ООО НПП «Доза», Россия



Дозиметр клинический для контроля радиологических процедур серии VacuDap System, производства VacuTec, Meßtechnik GmbH, Германия.



Крепление детское универсальное по ТУ 9452-001-80020198-2010,
производства ИП Давлетов Д.Я., Россия

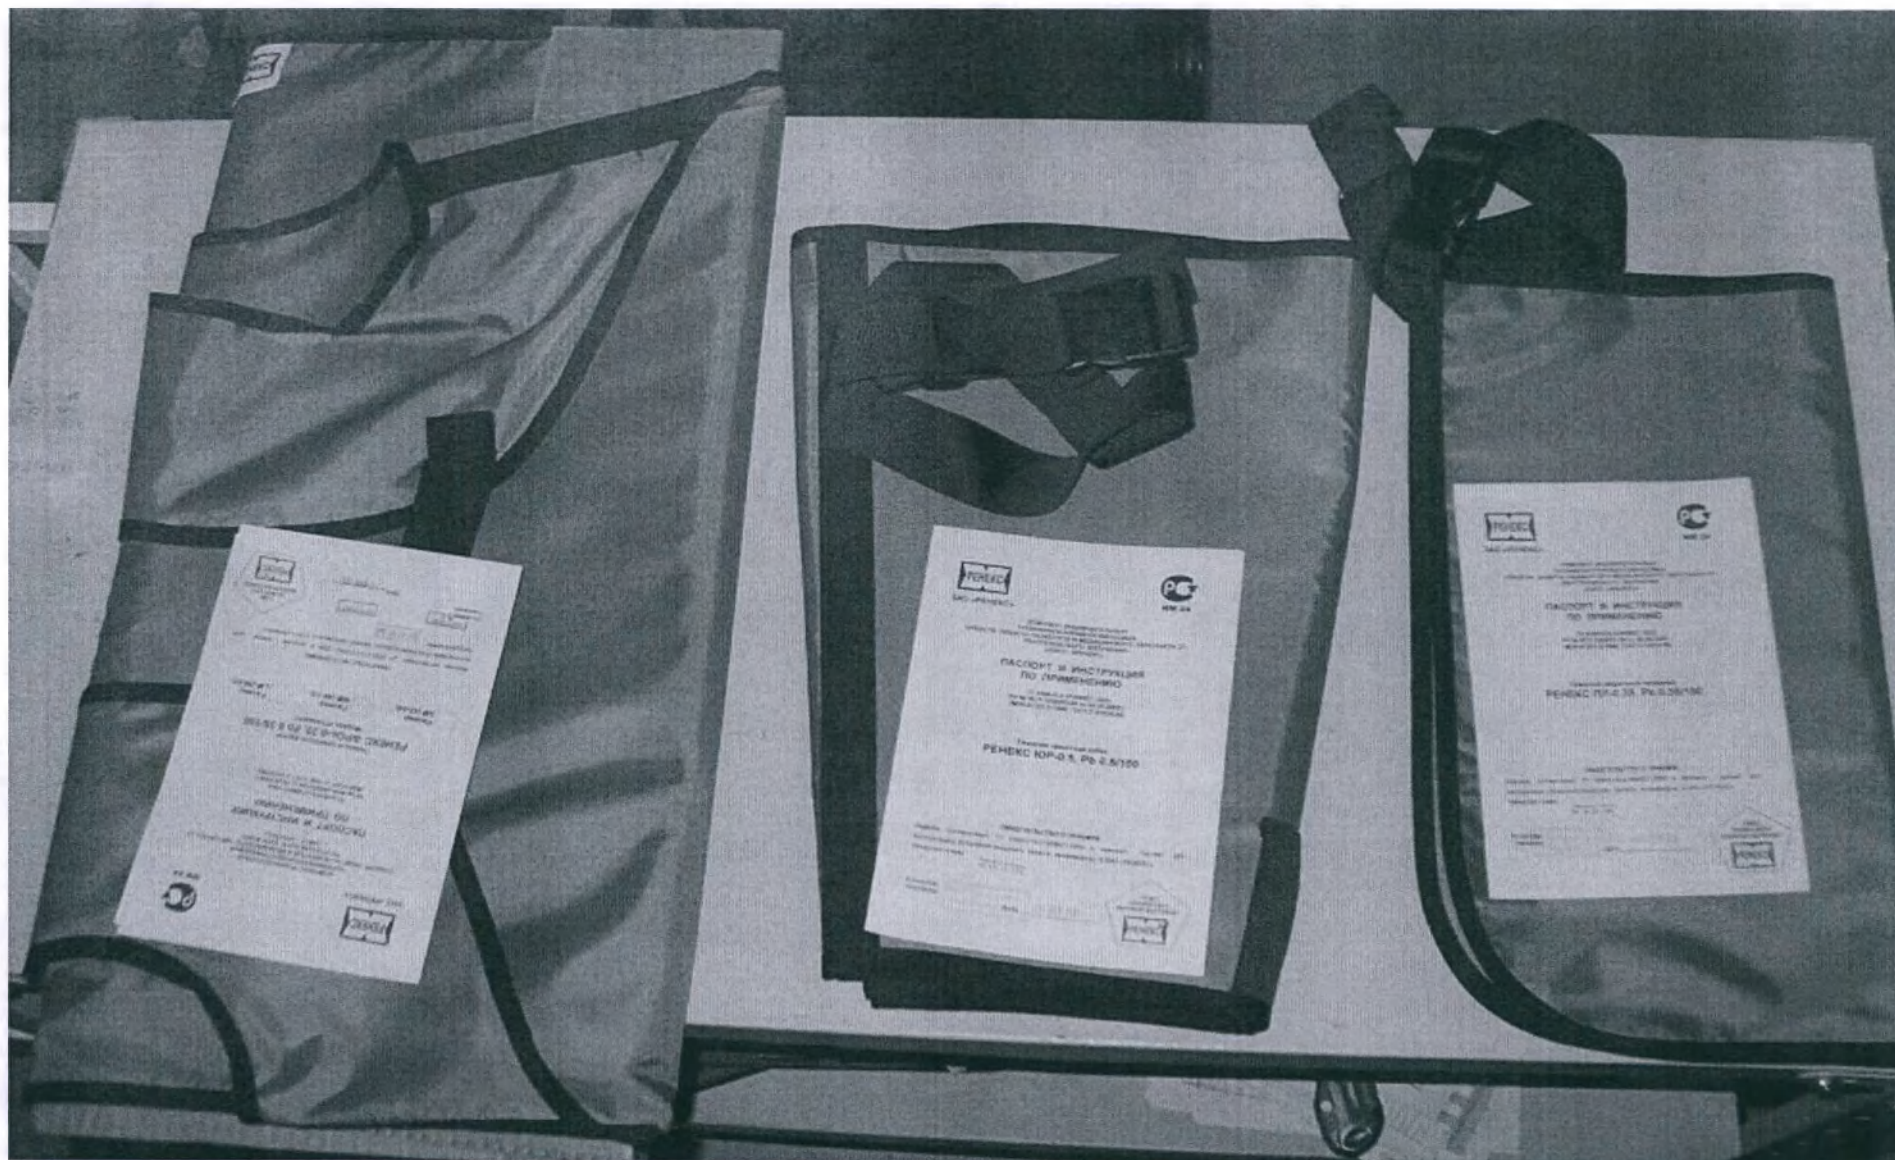


Комплект индивидуальных поливинилхлоридносвинцовых средств защиты пациентов и медицинского персонала от рентгеновского излучения КИСЗ-«РЕНЕКС» по ТУ 9398-010-21009821-2004, производства ЗАО «Ренекс», Россия




Комплекты рентгенозащитных средств из материала резиносвинцового для индивидуальной защиты врача, пациента и для использования в микропедиатрии при рентгенодиагностических исследованиях КСИЗ-РС и КСИЗмп-РС по ТУ 9452-001-42879986-2006, производства ООО «МП НПФ «Гаммамед-П», Россия



Комплект индивидуальных средств защиты пациентов и медицинского персонала от рентгеновского излучения КСИЗ-«ПРОМЕТ» по ТУ 14.12.30-001-39575739-2019, производства ООО «ПРОМЕТ ПЕРСОНАЛ ПРОТЭКШЭН», Россия

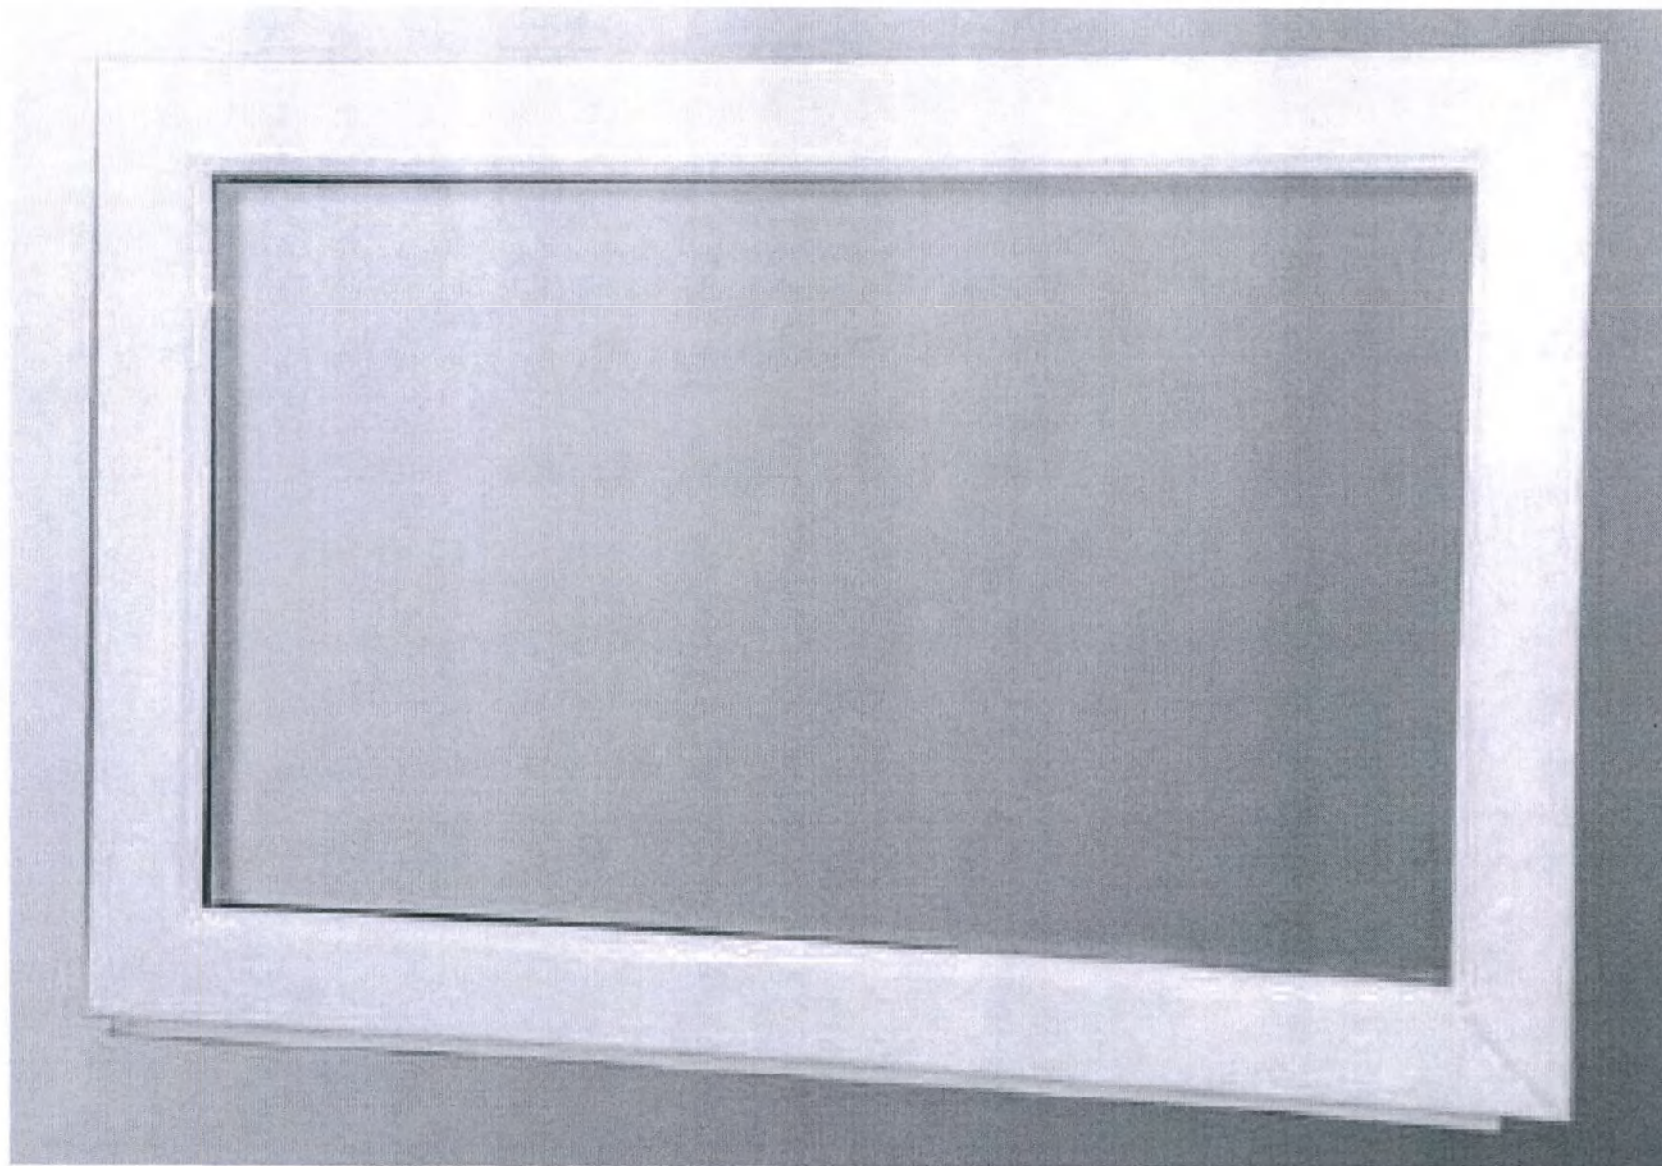

Окно рентгенозащитное размером не менее 1000×500 мм серии MACO, производства Hans O.Mahn & Co. KG, Германия или РЕНЕКС ОСРЗ производства ЗАО «Ренекс», Россия

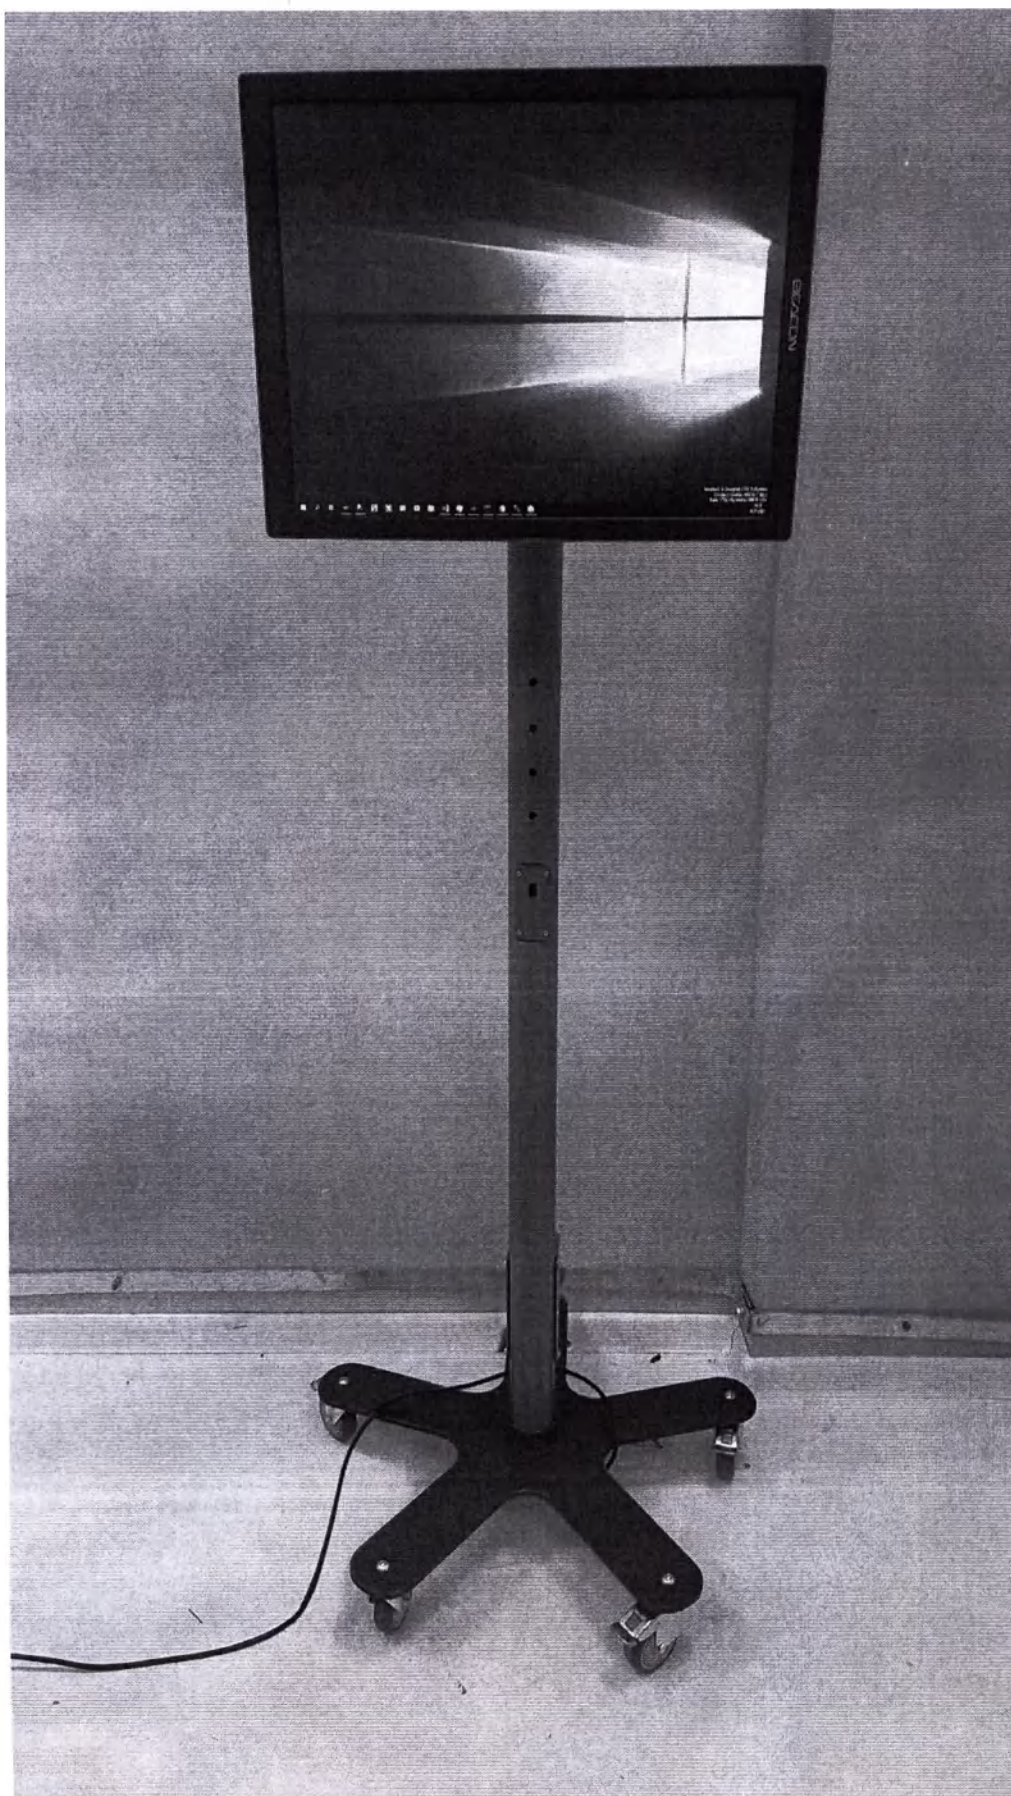

Стойка мониторная передвижная ОН-С0070, производства ООО «ВКО Медпром», Россия

Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на 52

(Пятидесяти двух) листах


Генеральный директор
ООО «ВКО Медпром»

Мешеряков О.В.



**Макет маркировки и
упаковки медицинского
изделия
«Комплекс рентгеновский
диагностический
телеуправляемый
«Триумф»**

ООО
«ВКО
Медпром»

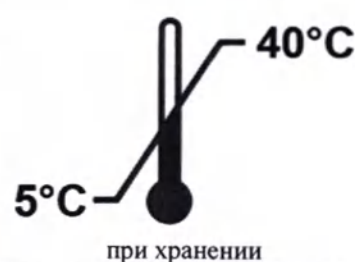


Комплекс рентгеновский диагностический телеуправляемый «Триумф»

Серийный номер:

Год и месяц упаковывания:

Место номер:

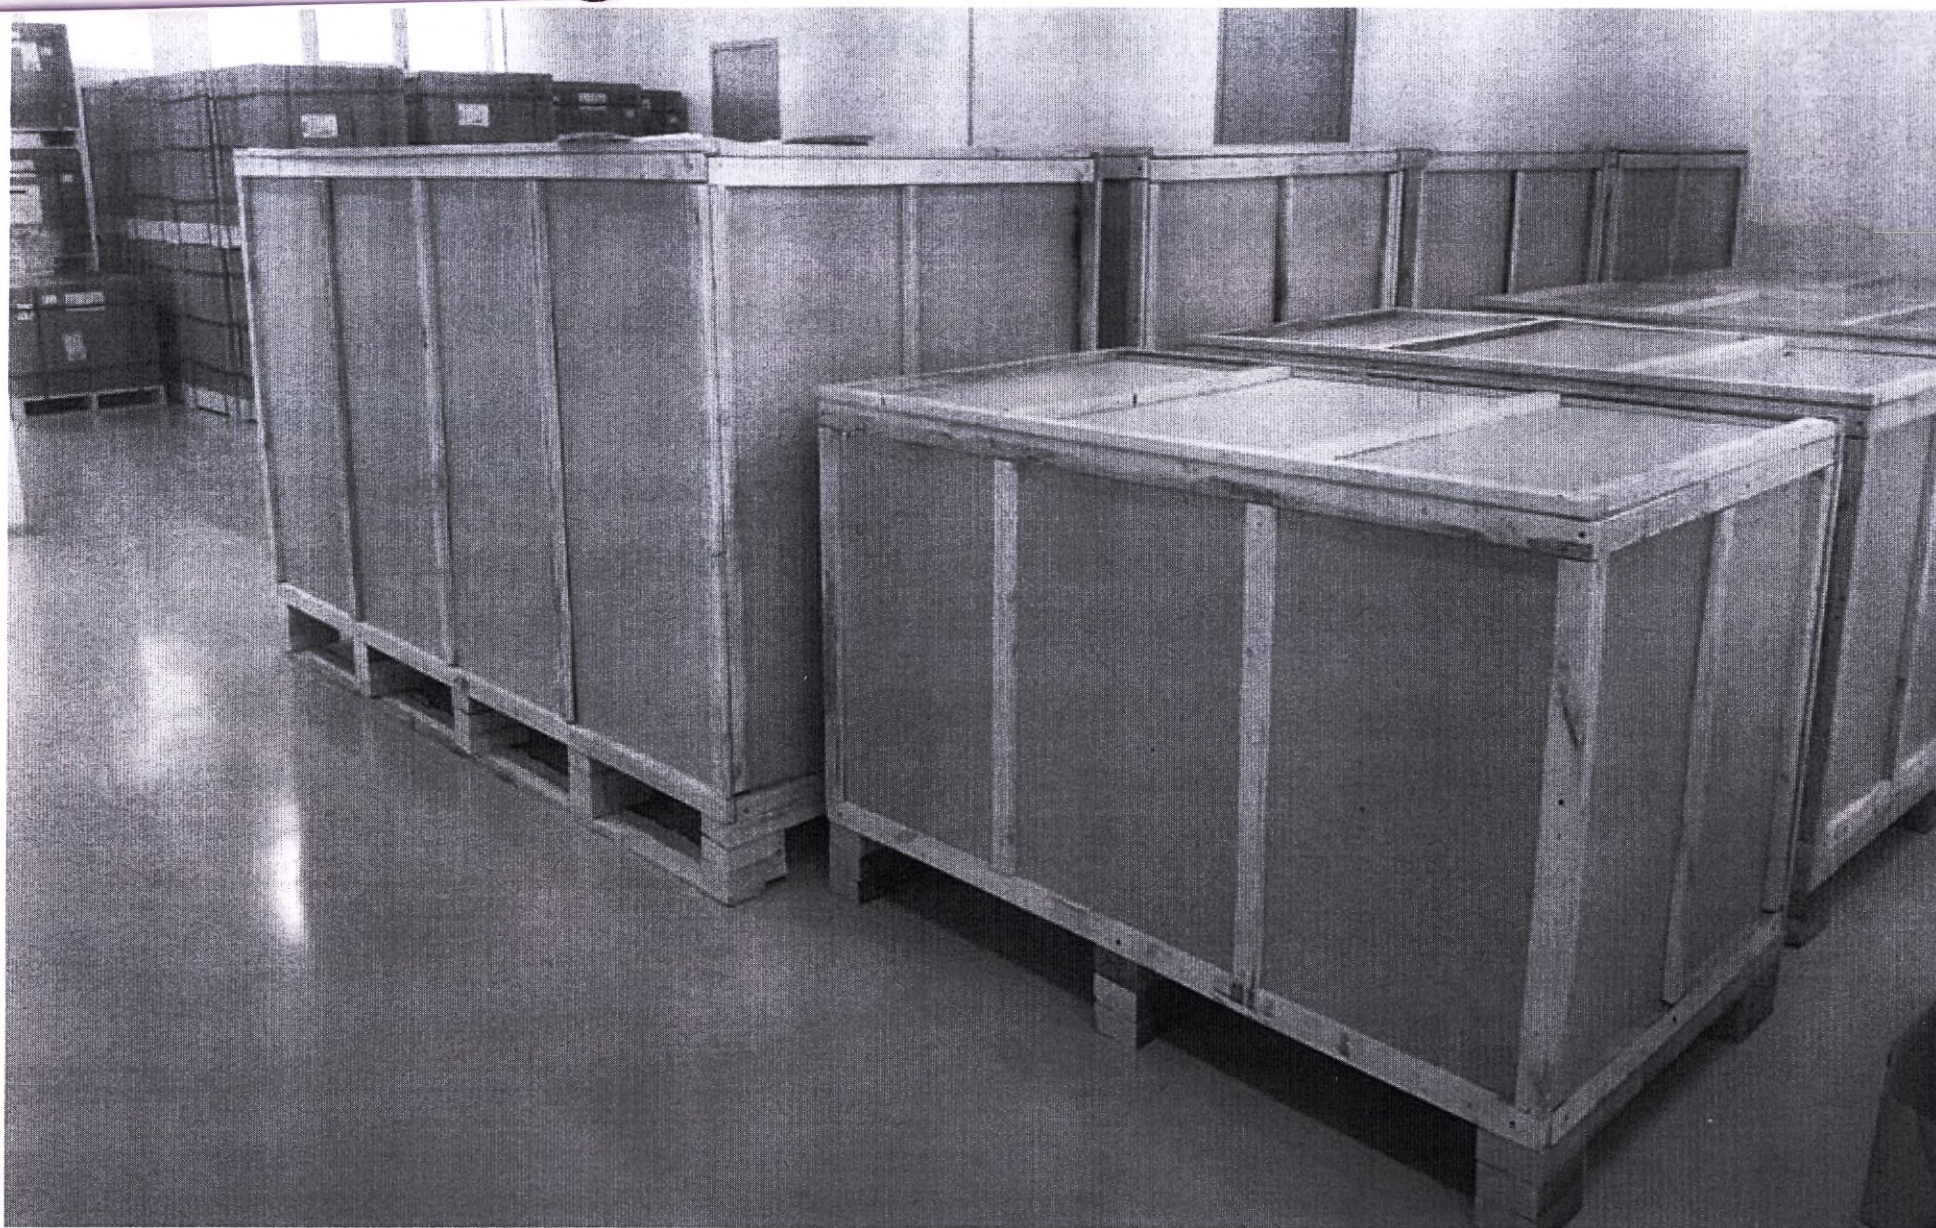

В зависимости от комплектации аппарат может быть упакован от 6 до 8 ящиков. В ящиках 7-8 расположены: Автоматизированное рабочее место врача-рентгенолога «ДИАРМ-МТ-Плюс» по ТУ 26.60.12-064-47245915-2018, Радиологическая информационная система «ИнтегрИС-МТ-Плюс» по ТУ 32.50.50-067-47245915-2019, Крепление детское универсальное по ТУ 9452-001-80020198-2010 и другие изделия поставляемые по согласованию с заказчиком. Изделия поставляются в оригинальной упаковке производителей.

Макет маркировки



Комплекс рентгеновский диагностический телеуправляемый «Триумф»

Обозначение	T1-A0000-0X, исполнение X
Технические условия	26.60.11-013-67684634-2022
Рег. удостоверение №	XXX XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX
Серийный номер	P-XX-XXX
Дата производства	XX.XXXX
Производитель	ООО «ВКО Медпром» для ООО «ВКМТ»



3N~380/400 В, 50 Гц, 100 кВ·А



X – значения указываются при поставке и после получении Регистрационного удостоверения

Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на 9

(темных) листах

Генеральный директор
ООО «ВКО Медпром»



Мешеряков О.В.