

# Фотографические изображения медицинского изделия

## *Система диагностическая ультразвуковая Aplio a- серии с принадлежностями*

**УТВЕРЖДАЮ**

Утверждаю

Генеральный директор

ООО «АрПи Канон Медикал Системз»



Д.В. Чередниченко

25 сентября 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью «АрПи Канон Медикал Системз» настоящим сообщает, что медицинское изделие «Система диагностическая ультразвуковая Aplio a-серии с принадлежностями» выпускается в двух вариантов исполнения.

Поскольку базовые составы отличаются лишь основными блоками системы, то на фотографических изображениях представлены фотографии покрывающие базовый состав для обоих вариантов исполнения Системы диагностической ультразвуковой Aplio a-серии.

Также список принадлежностей к обоим вариантам исполнения Системы диагностической ультразвуковой Aplio a-серии практически идентичен. Представлены фотографические изображения, покрывающие принадлежности для двух вариантов исполнения с указанием совместимости для варианта исполнения медицинского изделия.





Система диагностическая ультразвуковая Arlio a550 (модель CUS-AA550), общий вид







**CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION**

**1385 SHIMOISHIGAMI, OTAWARA-SHI, TOCHIGI, 324-8550,  
JAPAN**

---

**Система диагностическая ультразвуковая  
Aplio a550 (модель CUS-AA550)**

---

**ООО «АрПи Канон Медикал Системз»  
119421, Россия, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный  
округ Обручевский, Ленинский пр., д. 111, к. 1, эт. 5,  
ком. 129, тел. +7 (495) 626 58 09, +7 (495) 921 4948**

**Сделано в Японии**

Система диагностическая ультразвуковая Arlio a450 (модель CUS-AA450), общий вид







**CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION**

**1385 SHIMOISHIGAMI, OTAWARA-SHI, TOCHIGI, 324-8550,  
JAPAN**

---

**Система диагностическая ультразвуковая  
Aplio a450 (модель CUS-AA450)**


---

**ООО «АрПи Канон Медикал Системз»  
119421, Россия, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный  
округ Обручевский, Ленинский пр., д. 111, к. 1, эт. 5,  
ком. 129, тел. +7 (495) 626 58 09, +7 (495) 921 4948**

**Сделано в Японии**



1. Система диагностическая ультразвуковая Aplio a550 (модель CUS-AA550), в составе: 1. Блок системы Aplio a550 (CUS-AA550)

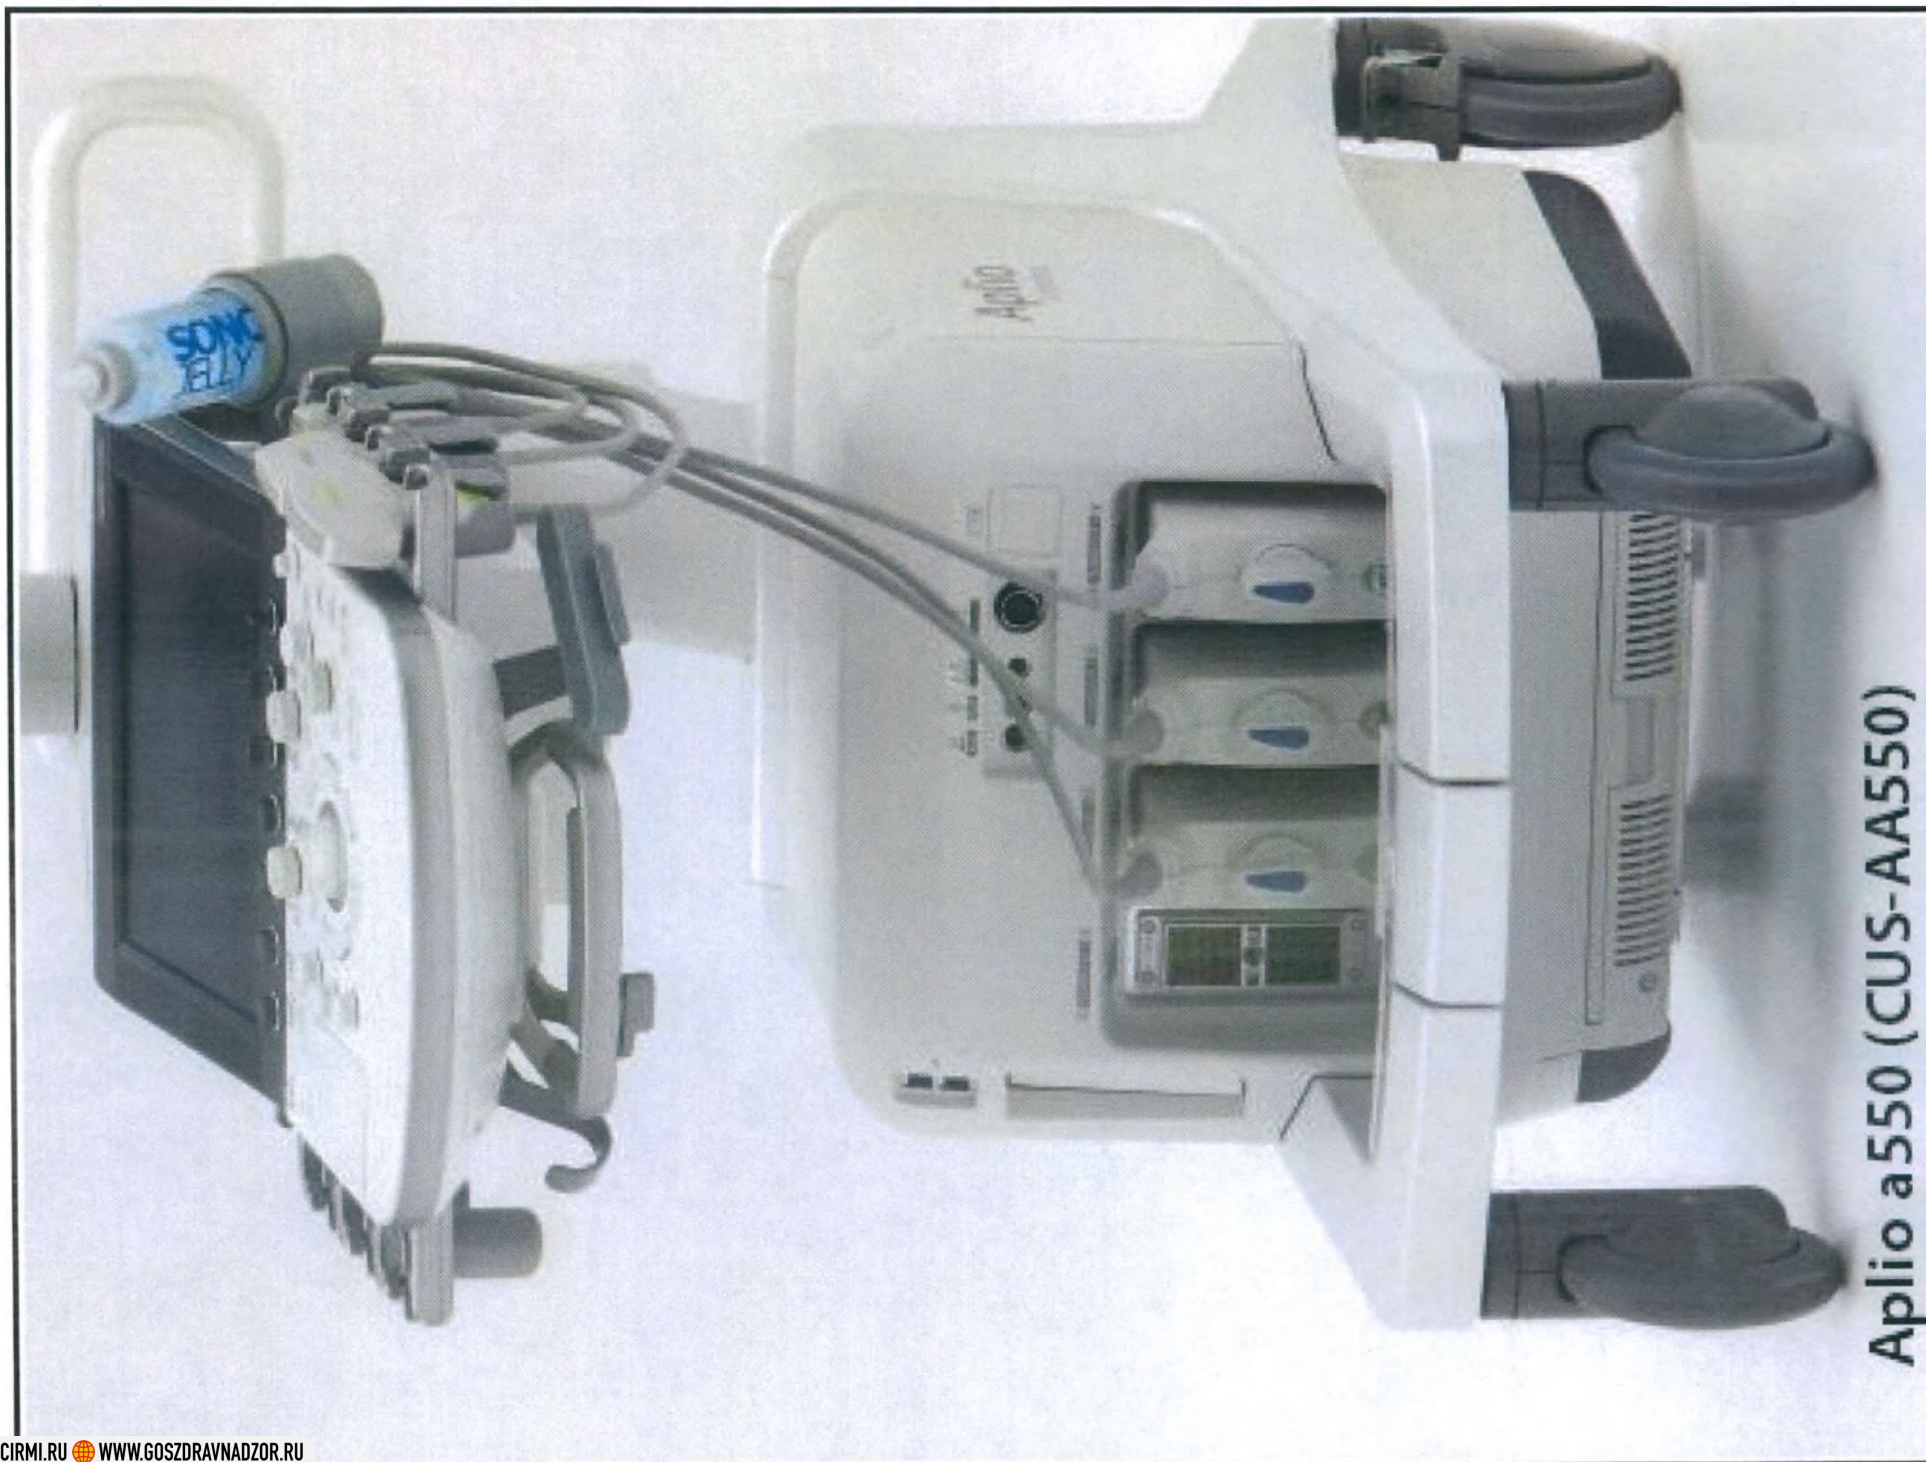

1. Система диагностическая ультразвуковая Aplio a450 (модель CUS-AA450) в составе: Блок системы Aplio a450 (модель CUS-AA450)







## 2. Программное обеспечение системы базовое



3. Монитор цветной жидкокристаллический с расширенной диагональю. (для варианта исполнения Aplio a550(модель CUS-AA550))

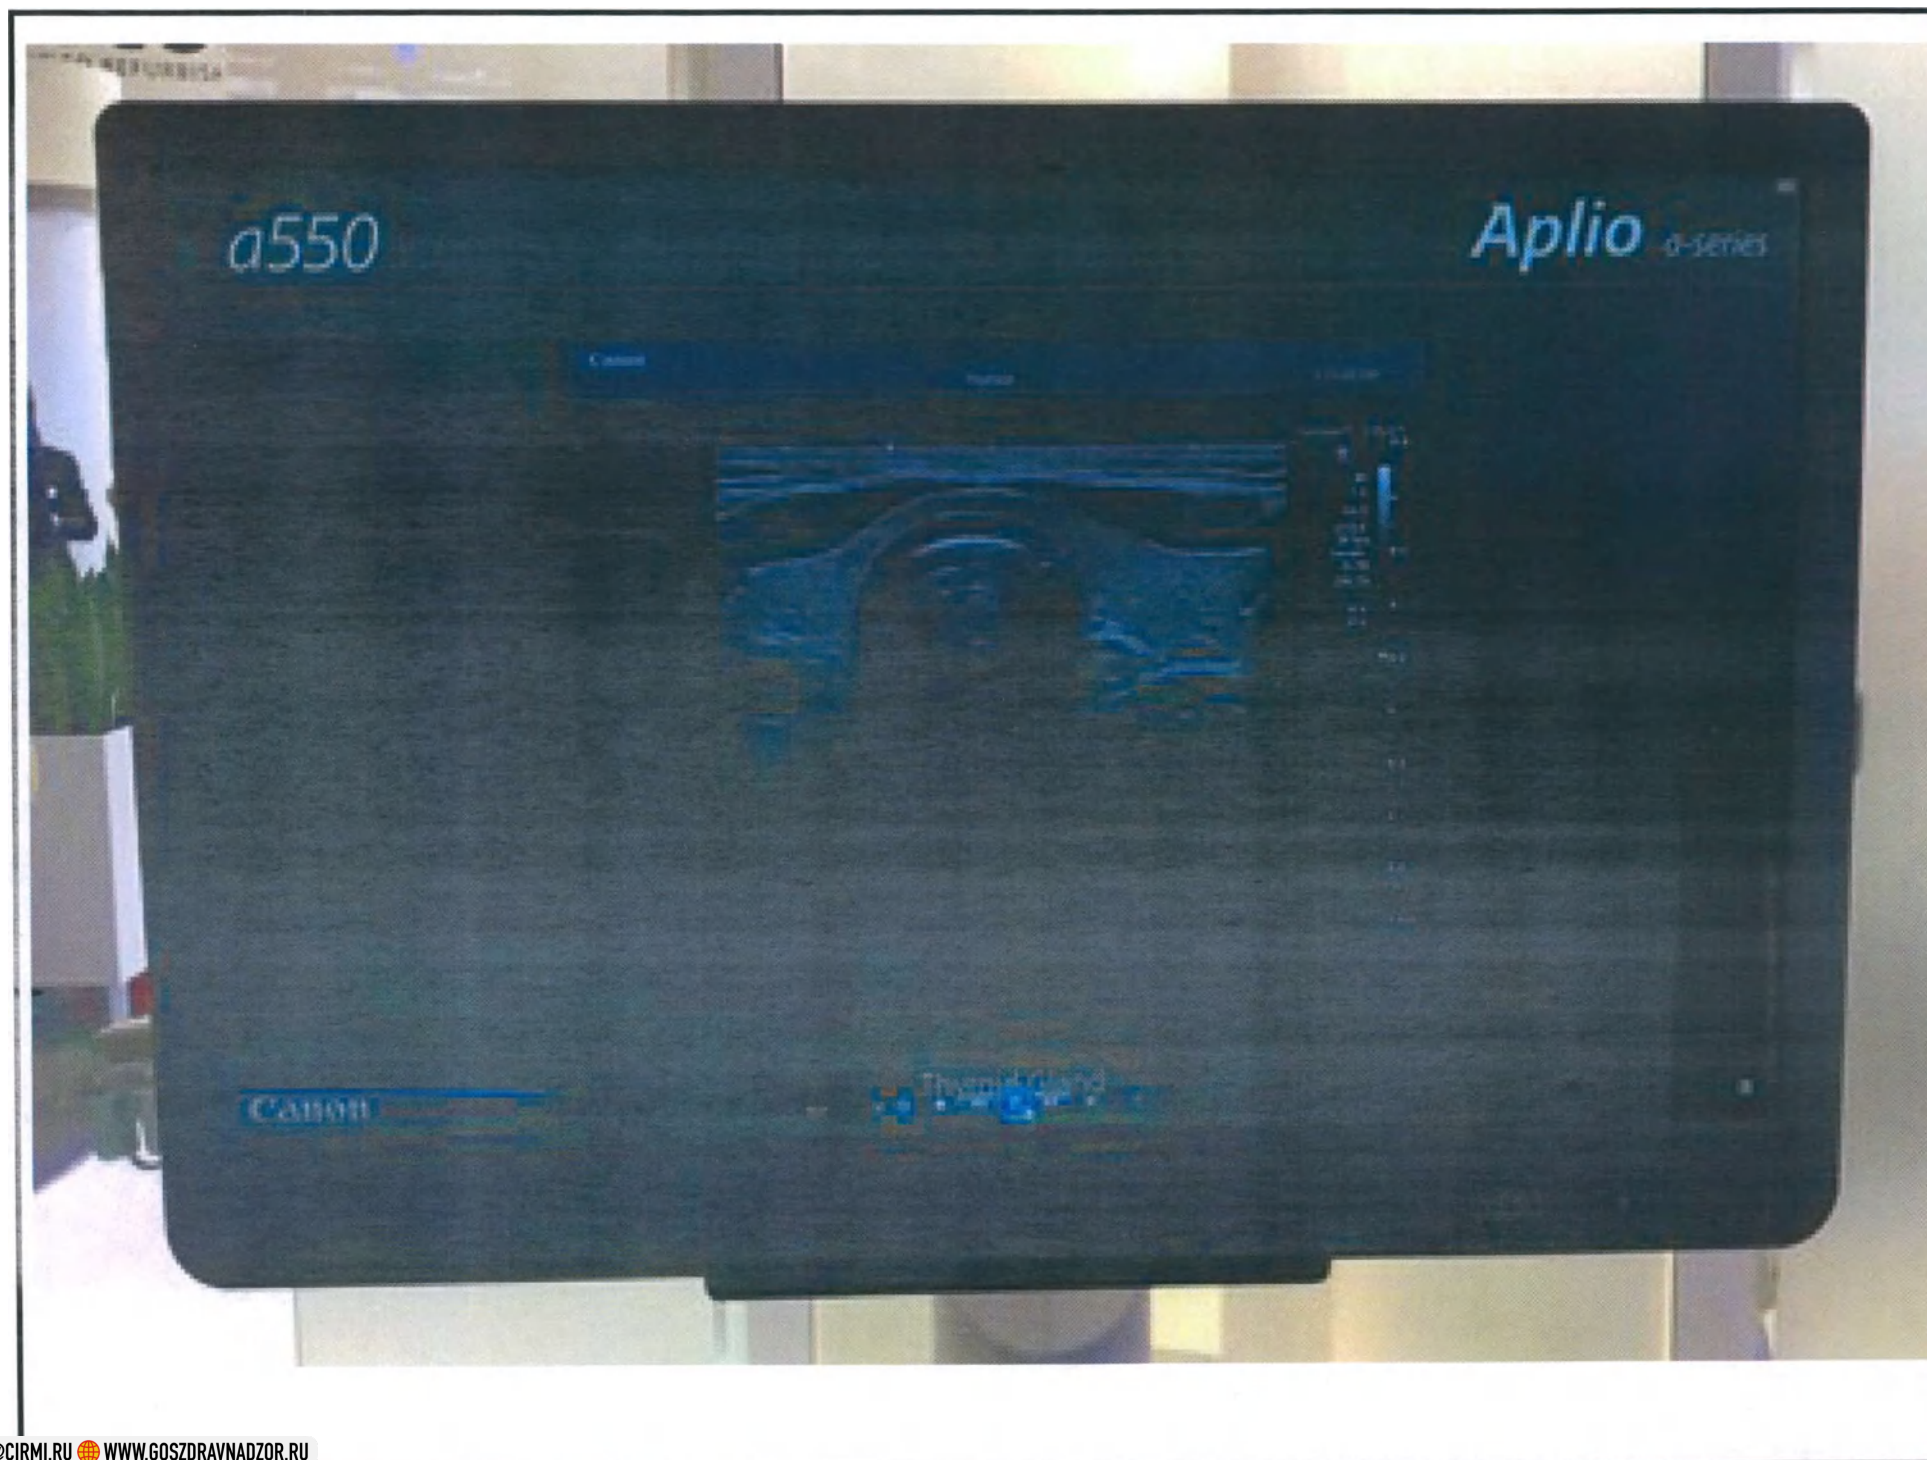




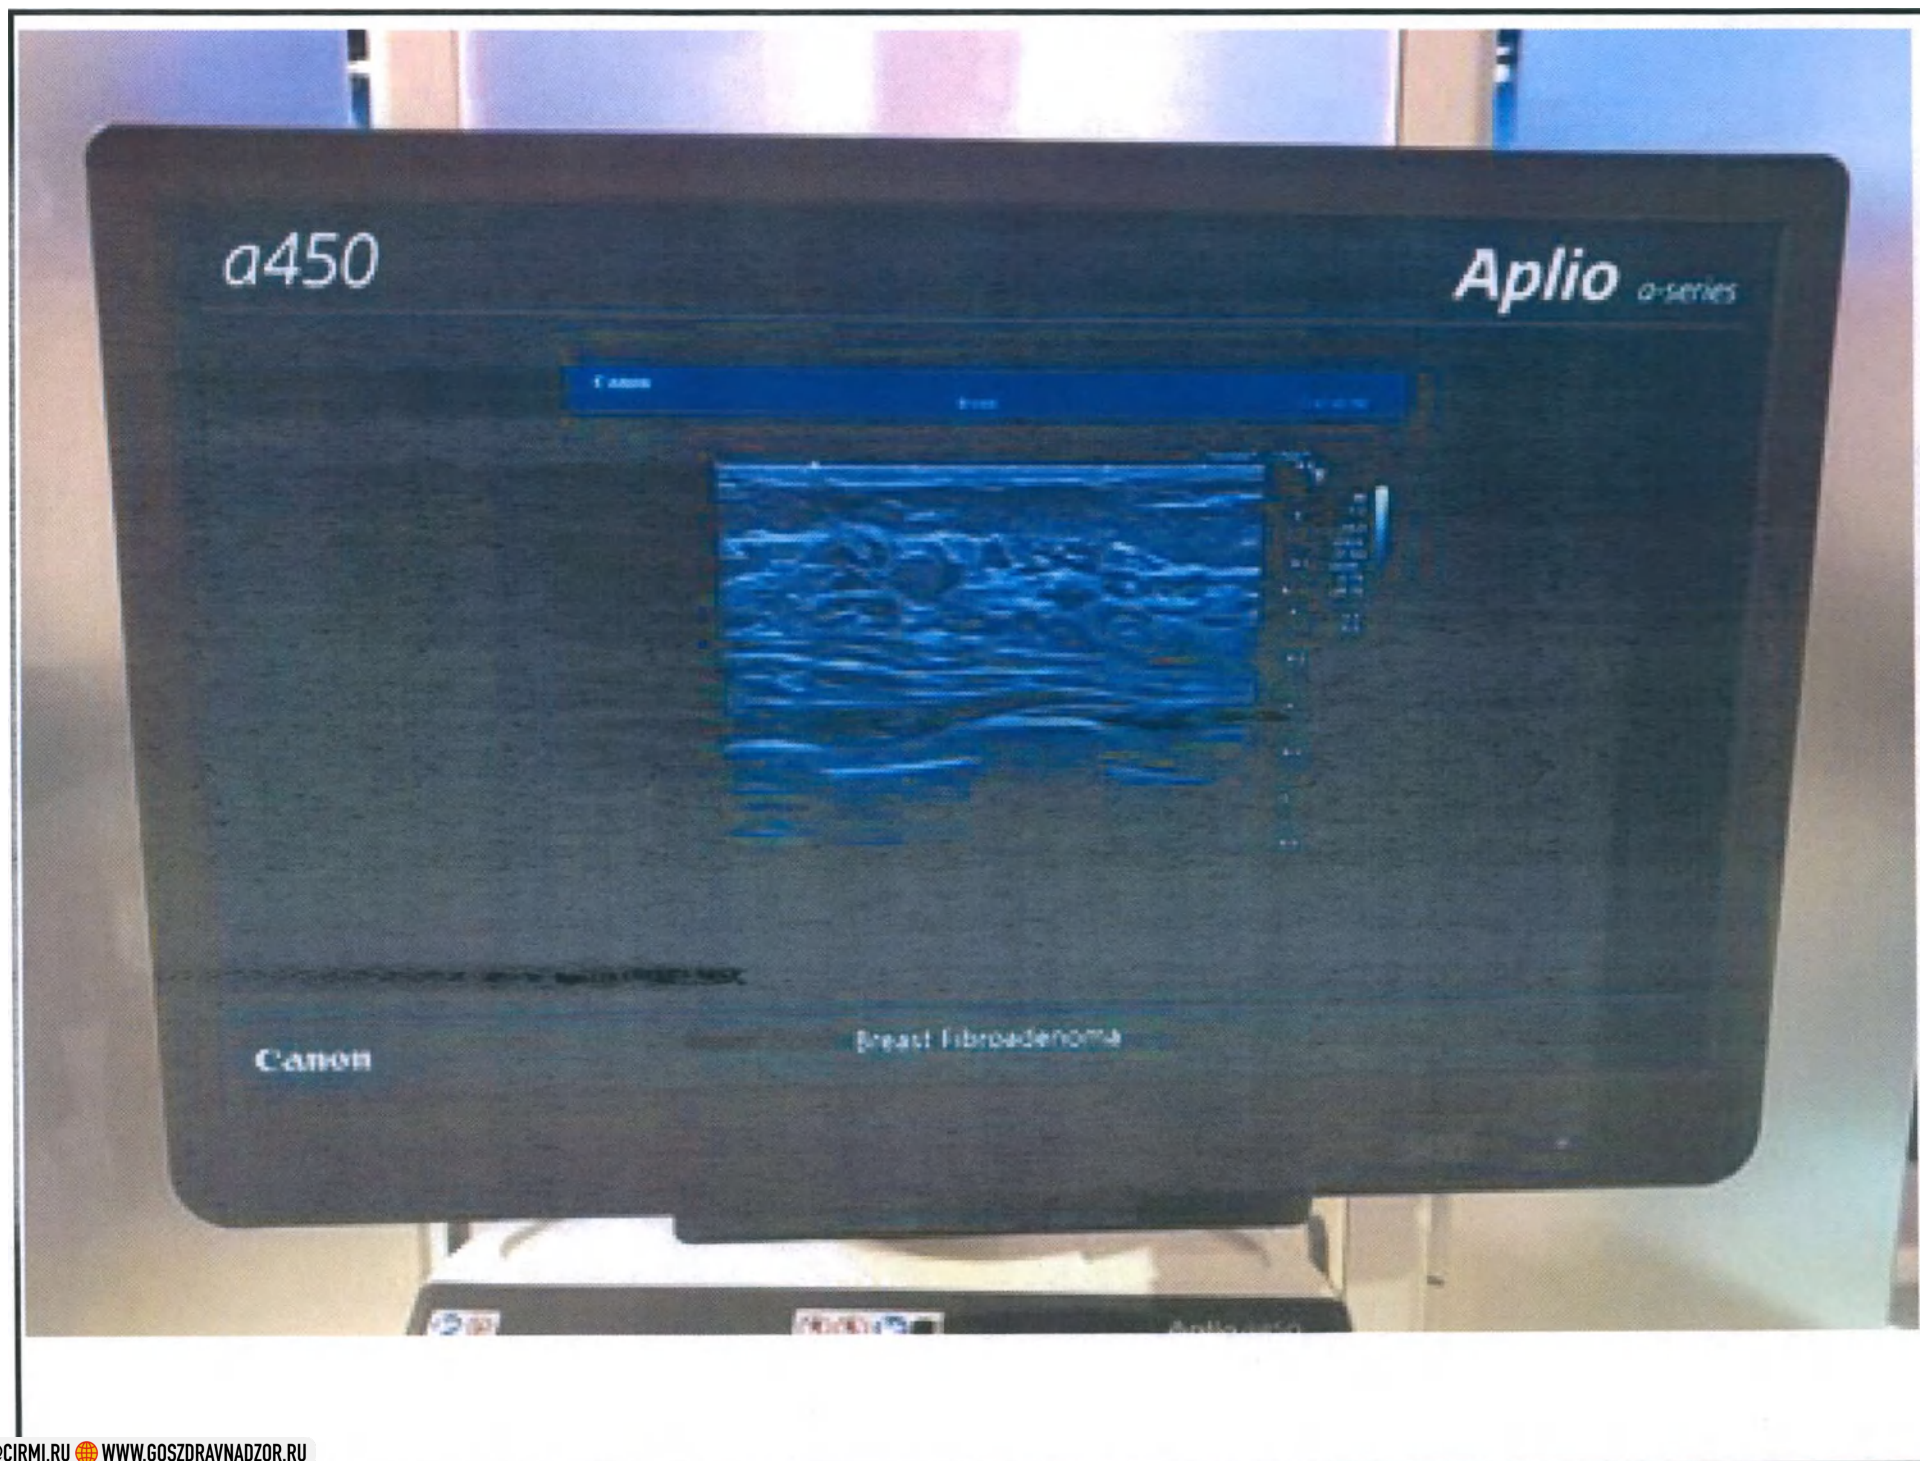



4. Датчик секторный, модель PST-25BT, производства Canon Medical Systems Corporation, Япония, РУ № РЗН 2020/11544 (при необходимости)

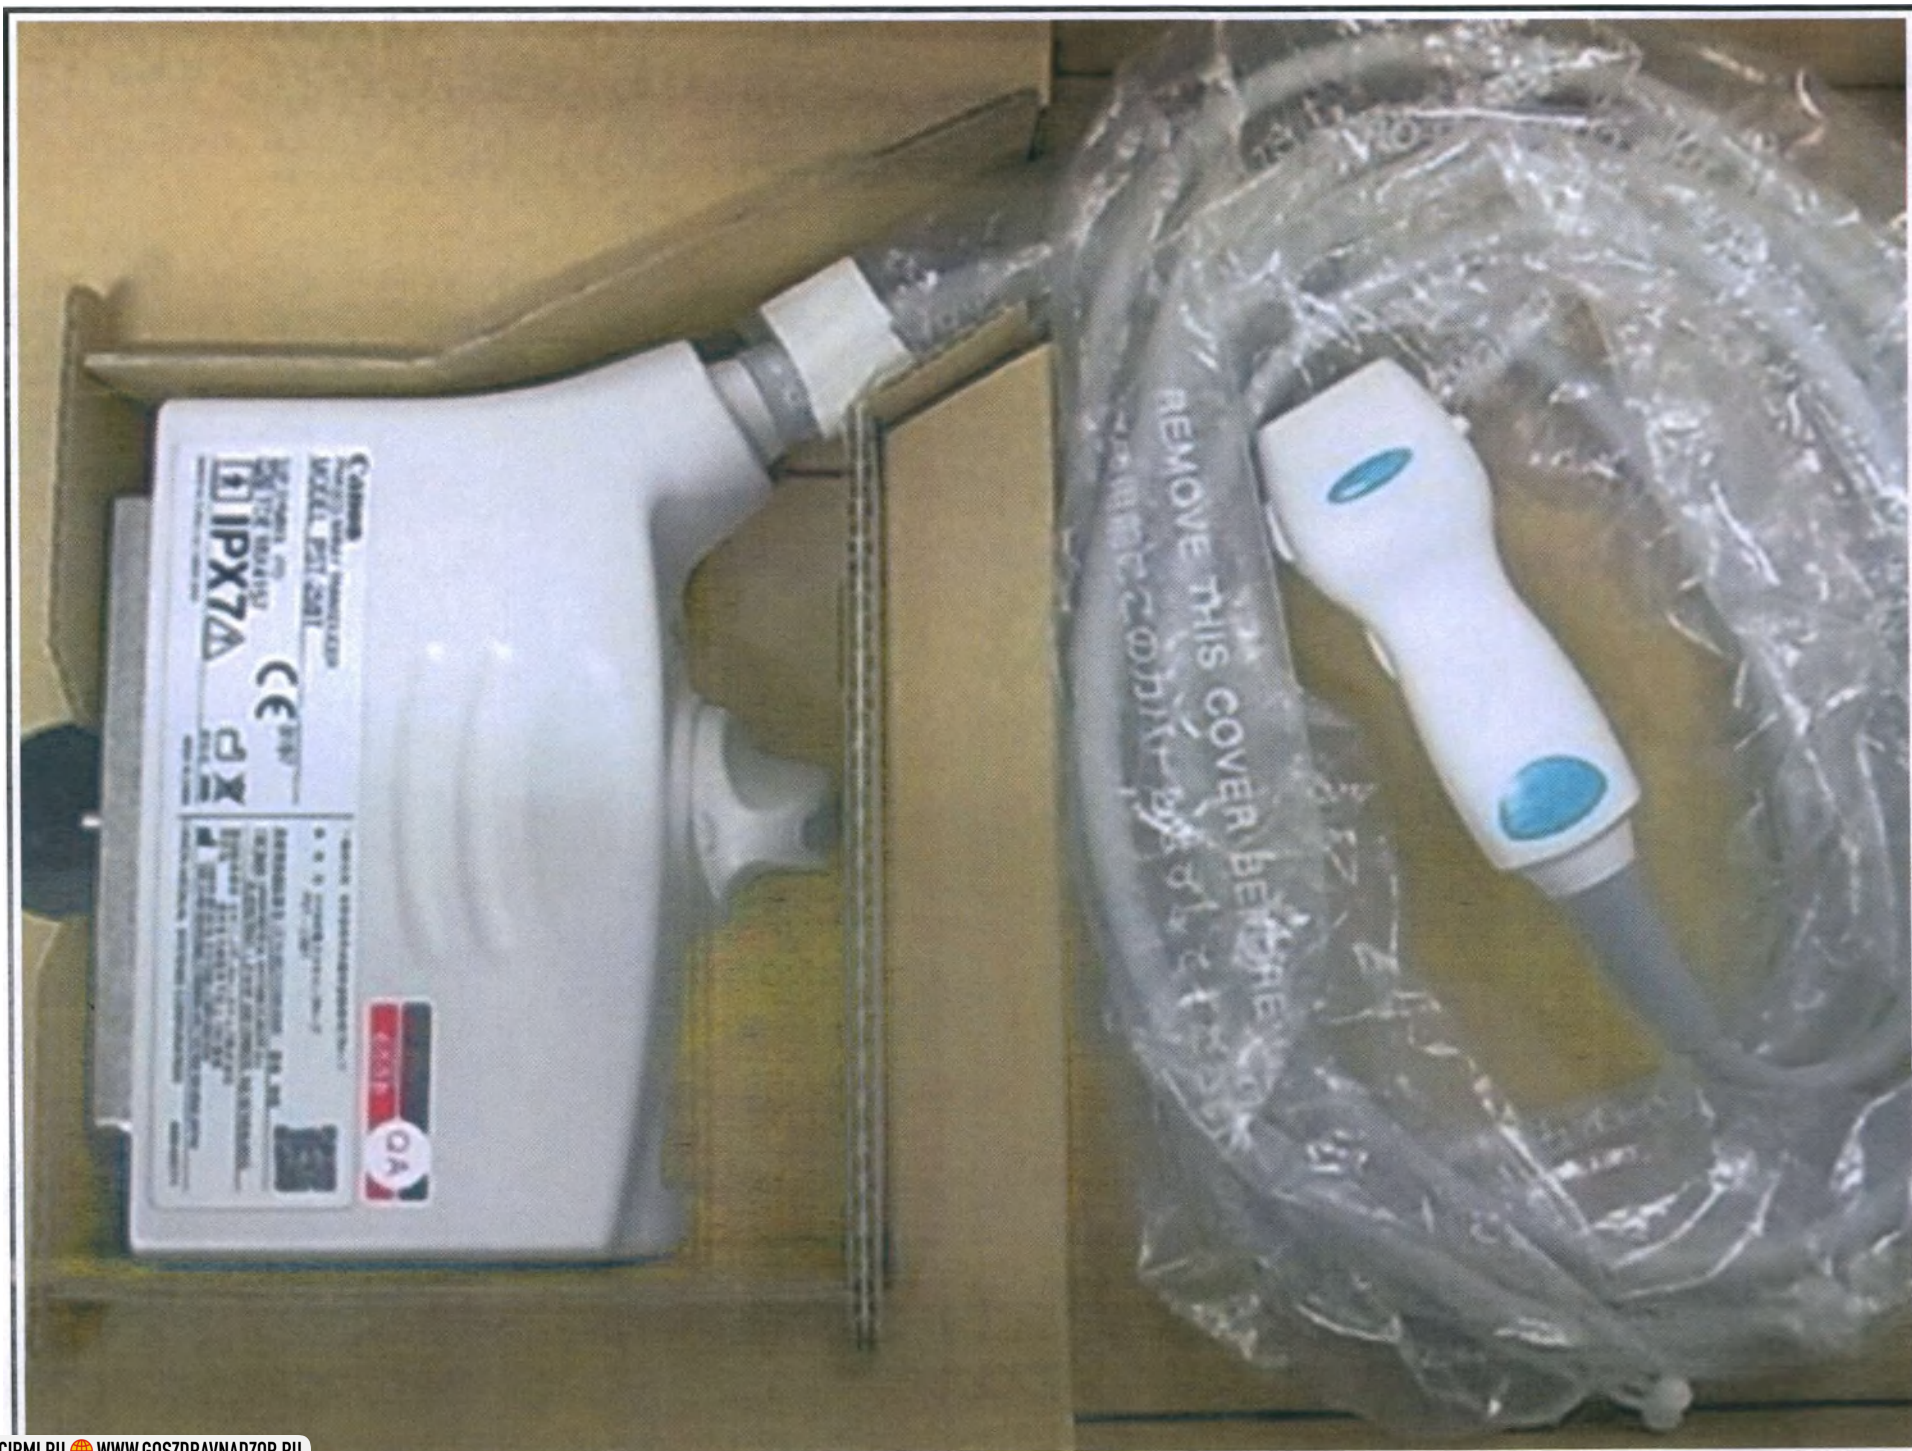




4. Датчик секторный, модель PST-25BT, производства Canon Medical Systems Corporation, Япония, РУ № РЗН 2020/11544 (при необходимости)





4. Датчик секторный, модель PST-25BT, производства Canon Medical Systems Corporation, Япония, РУ № РЗН 2020/11544 (при необходимости)

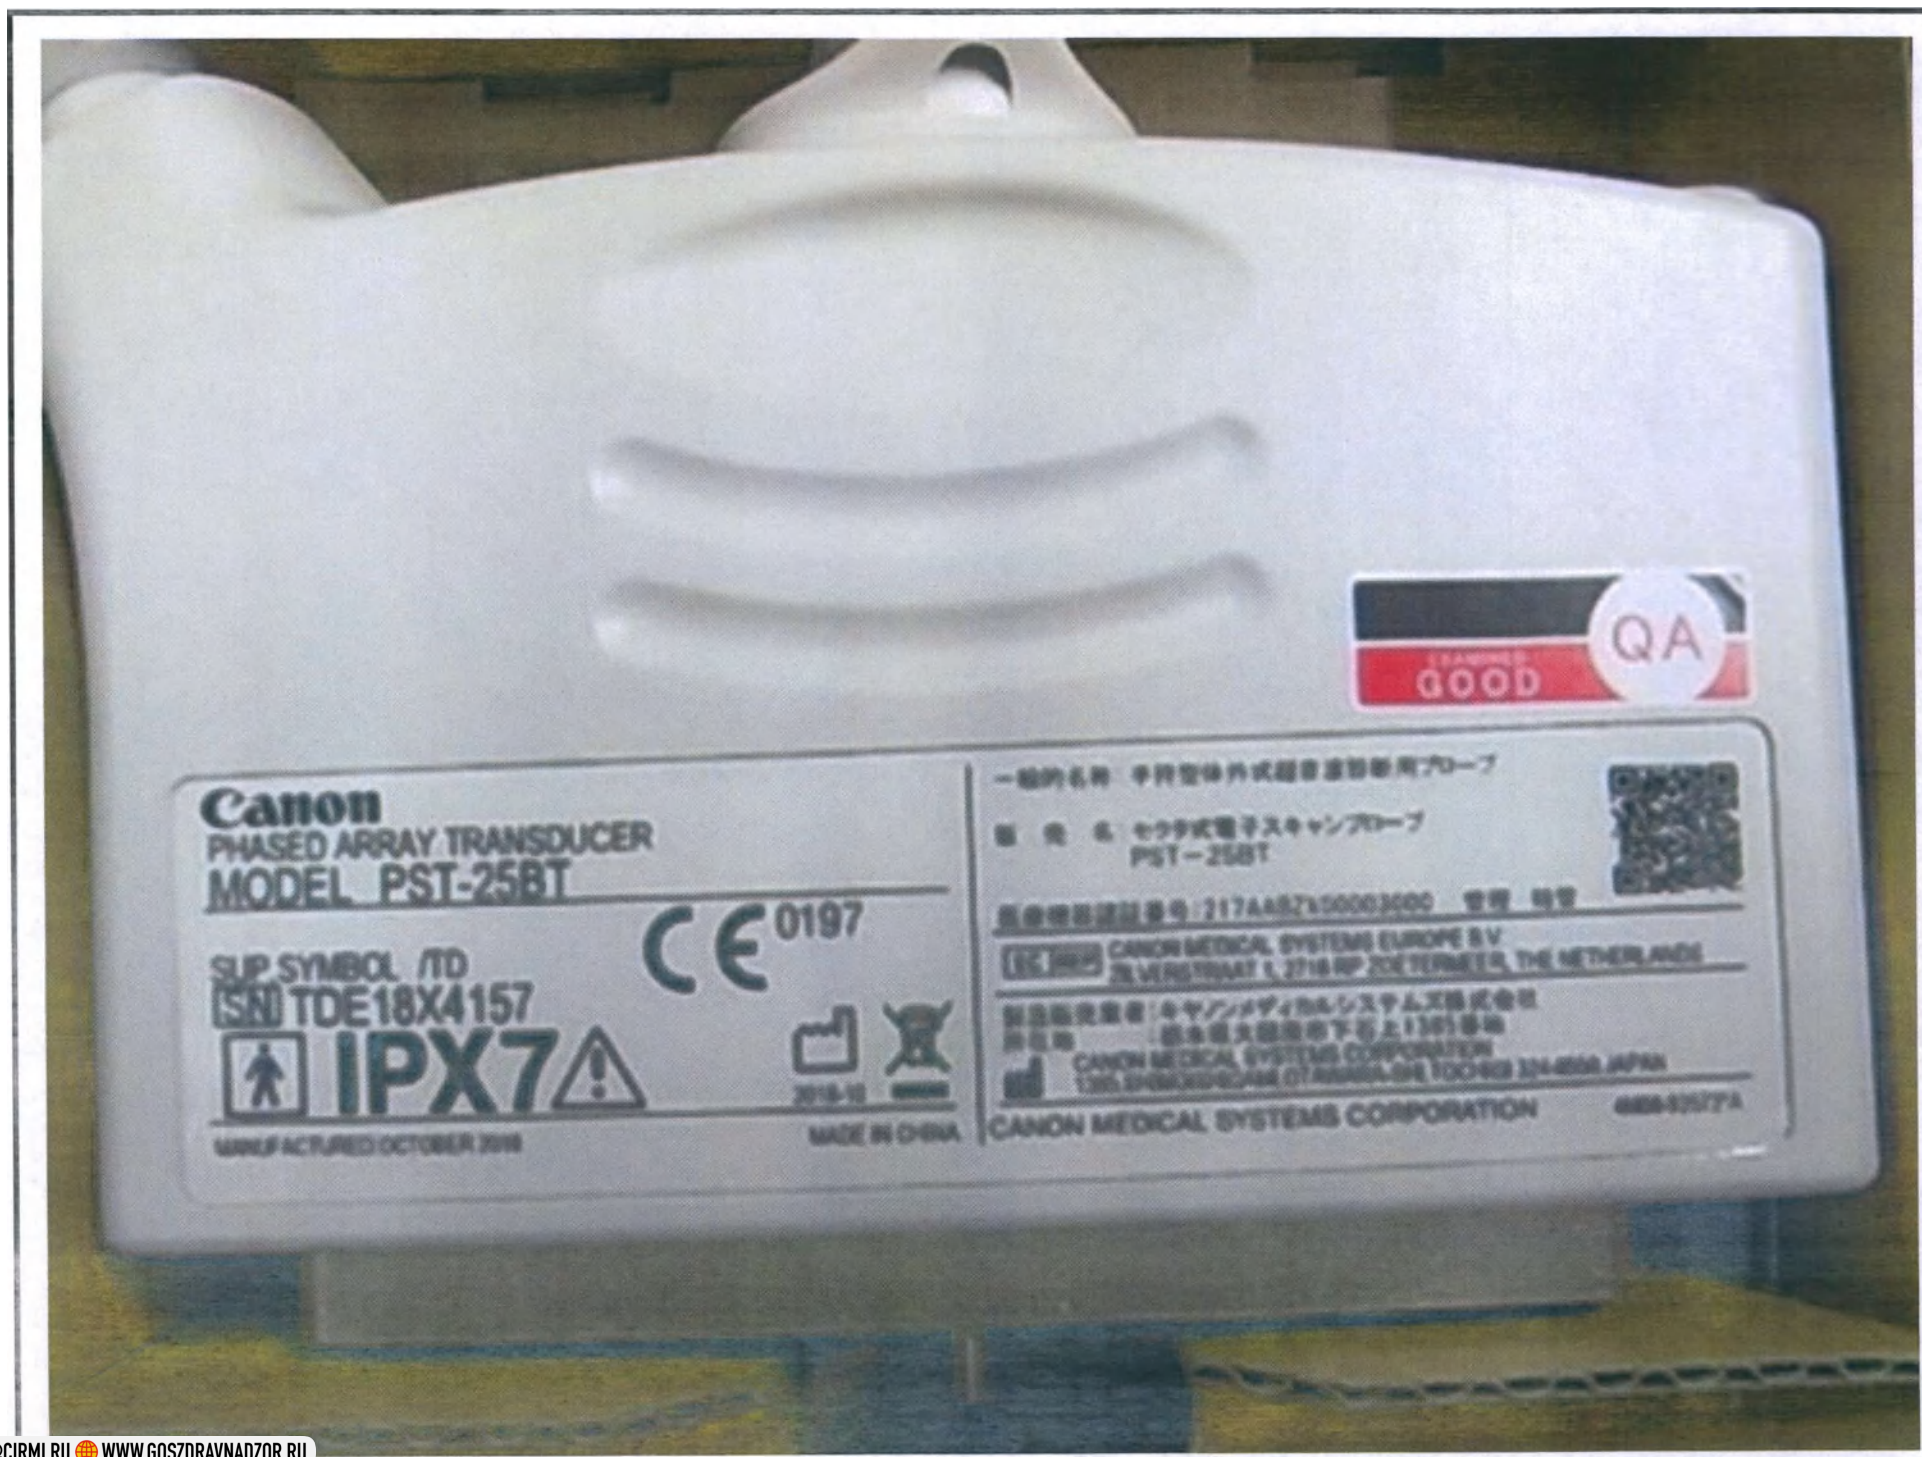



5. Датчик секторный, модель PST-30BT, производства Canon Medical Systems Corporation, Япония, РУ № РЗН 2020/11544 (при необходимости)






5. Датчик секторный, модель PST-30BT, производства Canon Medical Systems Corporation, Япония, РУ № РЗН 2020/11544 (при необходимости)






5. Датчик секторный, модель PST-30BT, производства Canon Medical Systems Corporation, Япония, РУ № РЗН 2020/11544 (при необходимости)

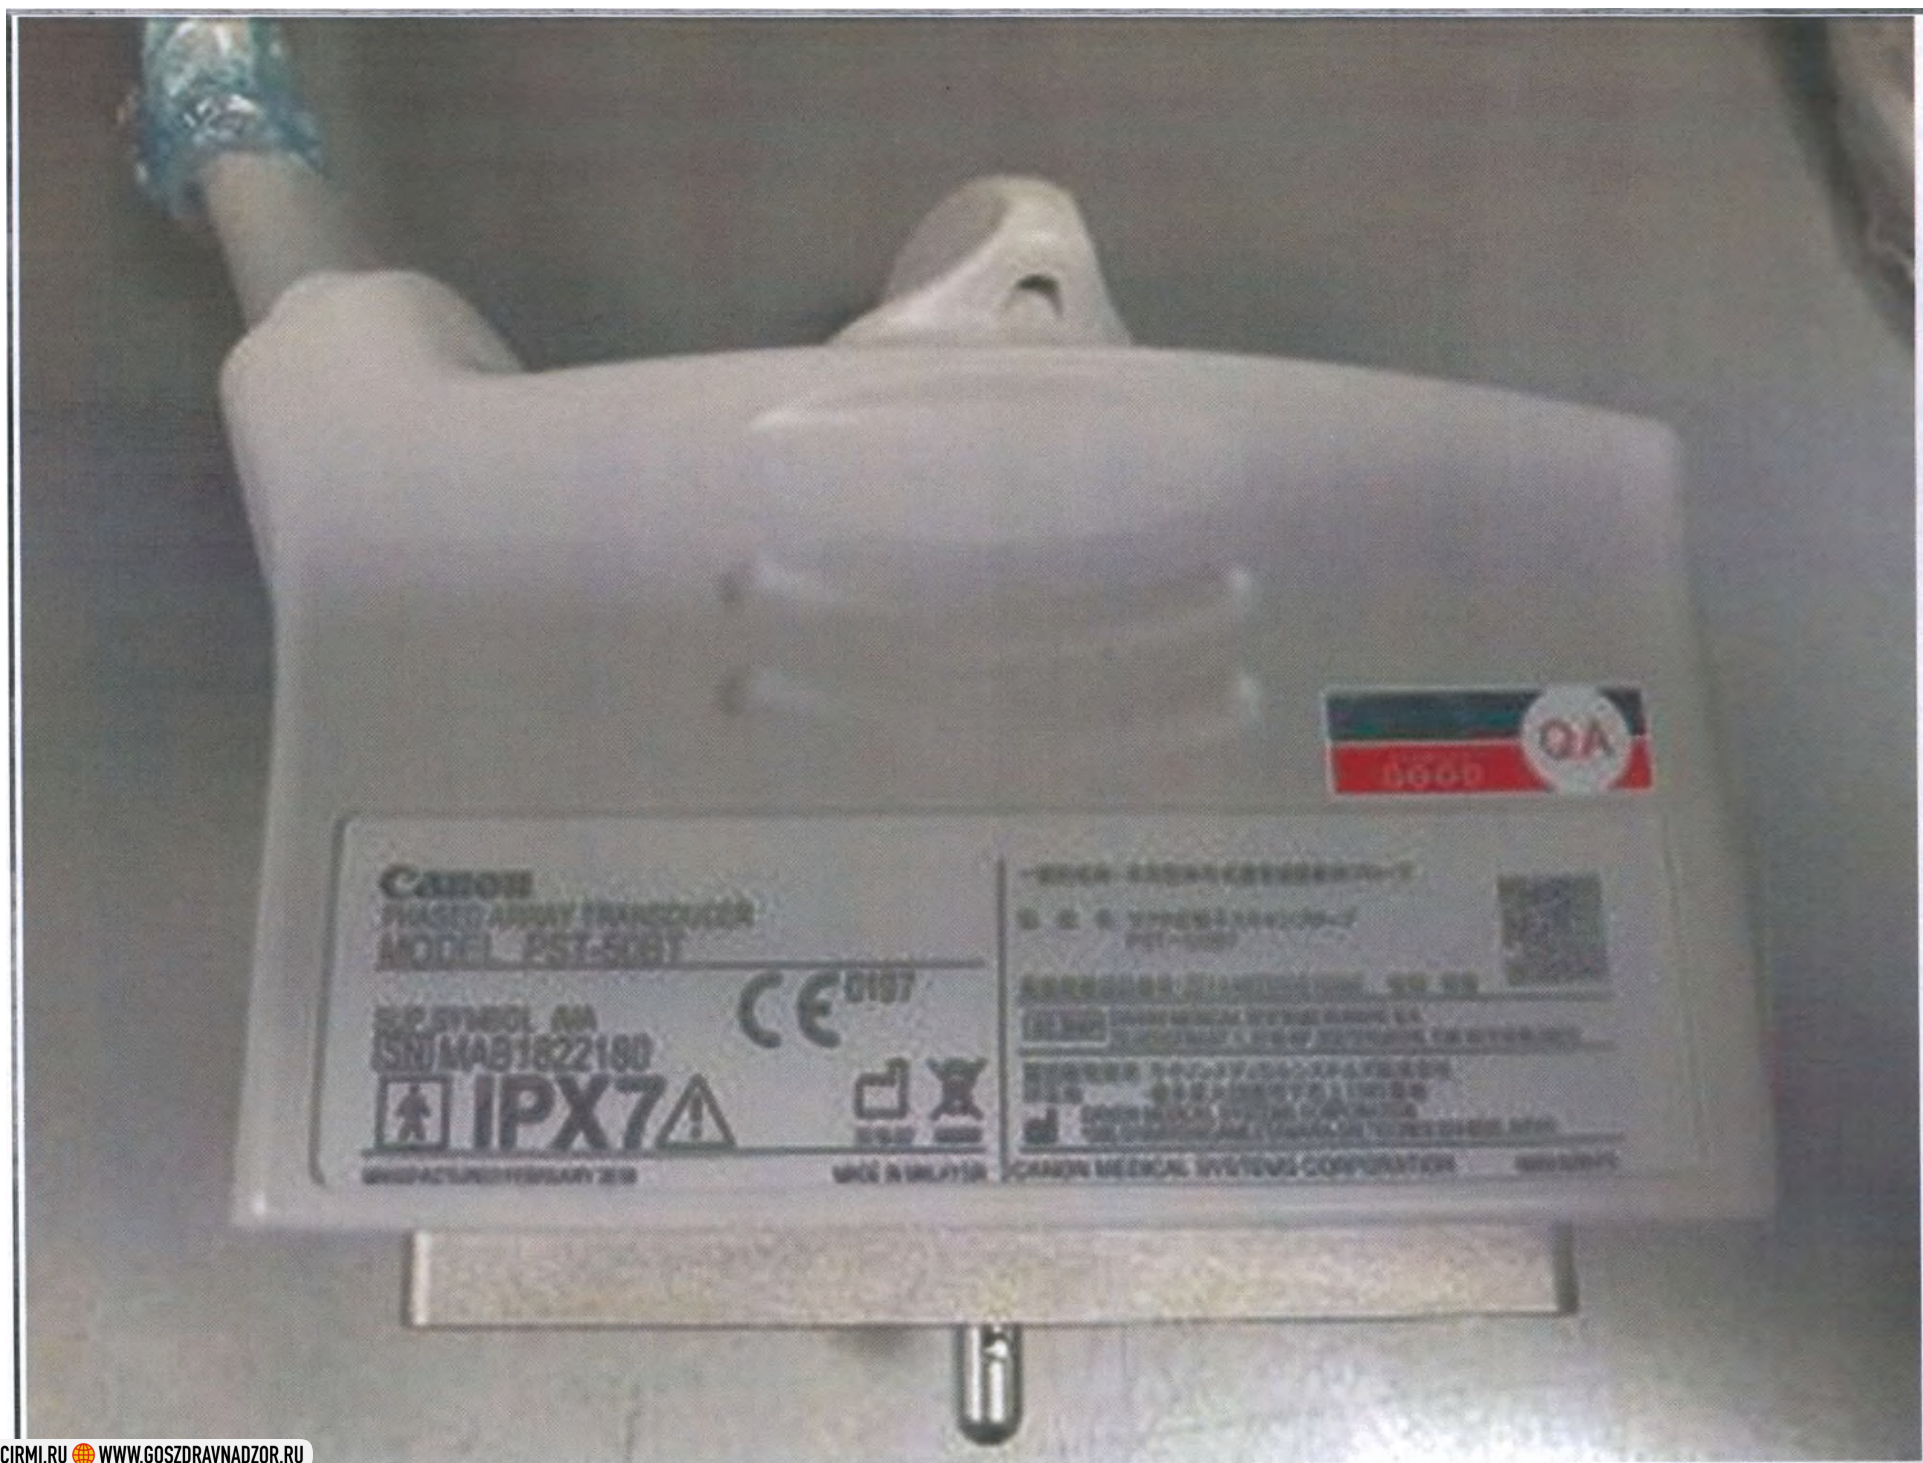




6. Датчик секторный, модель PST-50BT, производства Canon Medical Systems Corporation, Япония, РУ № РЗН 2020/11544 (при необходимости)

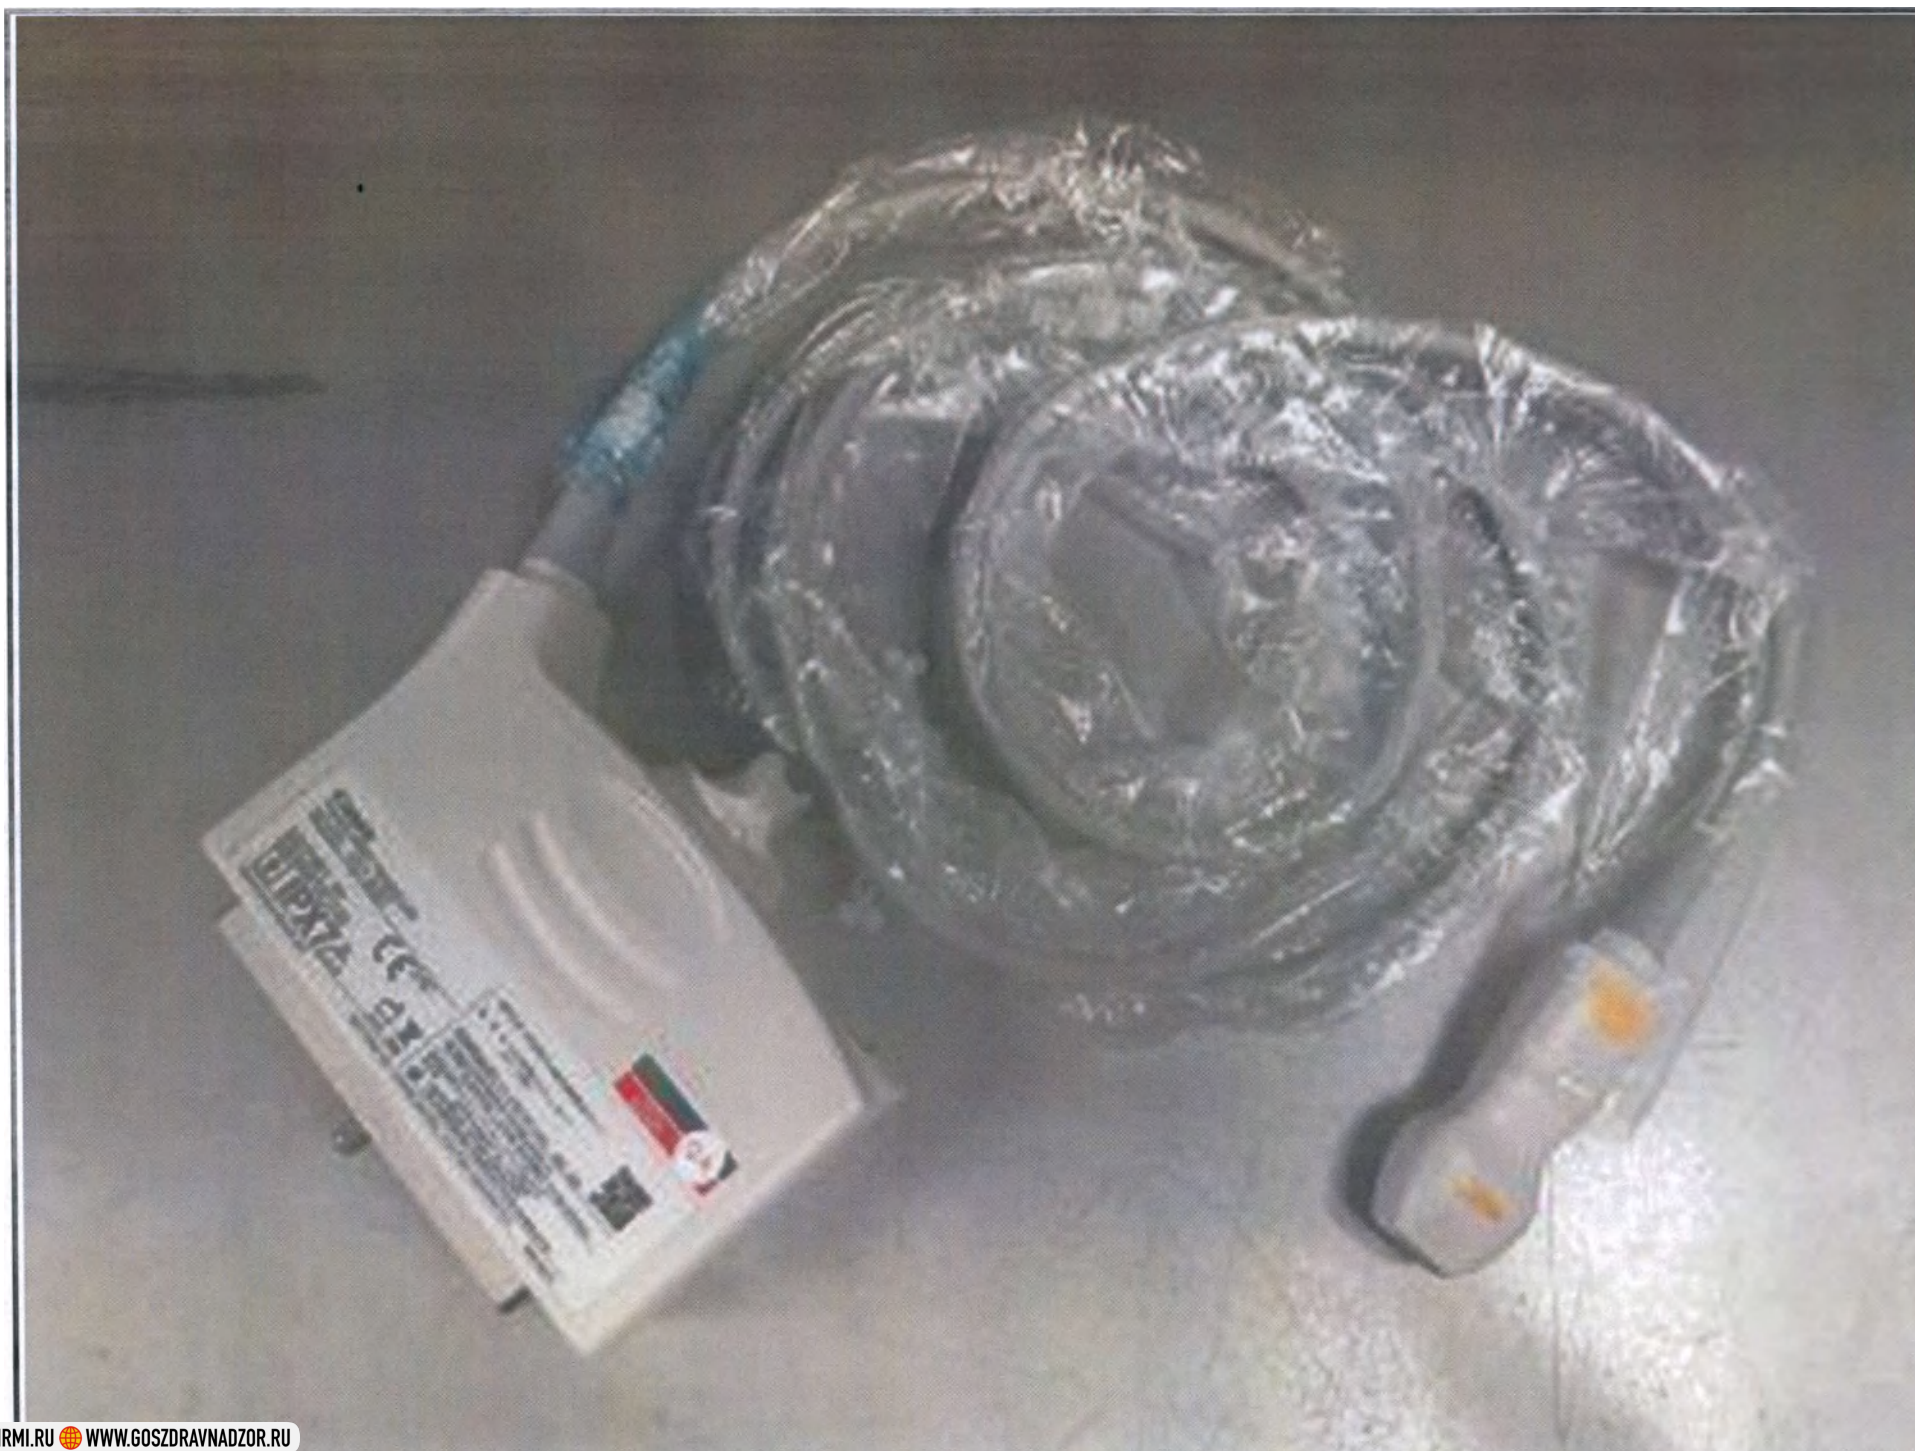




6. Датчик секторный, модель PST-50BT, производства Canon Medical Systems Corporation, Япония, РУ № РЗН 2020/11544 (при необходимости)

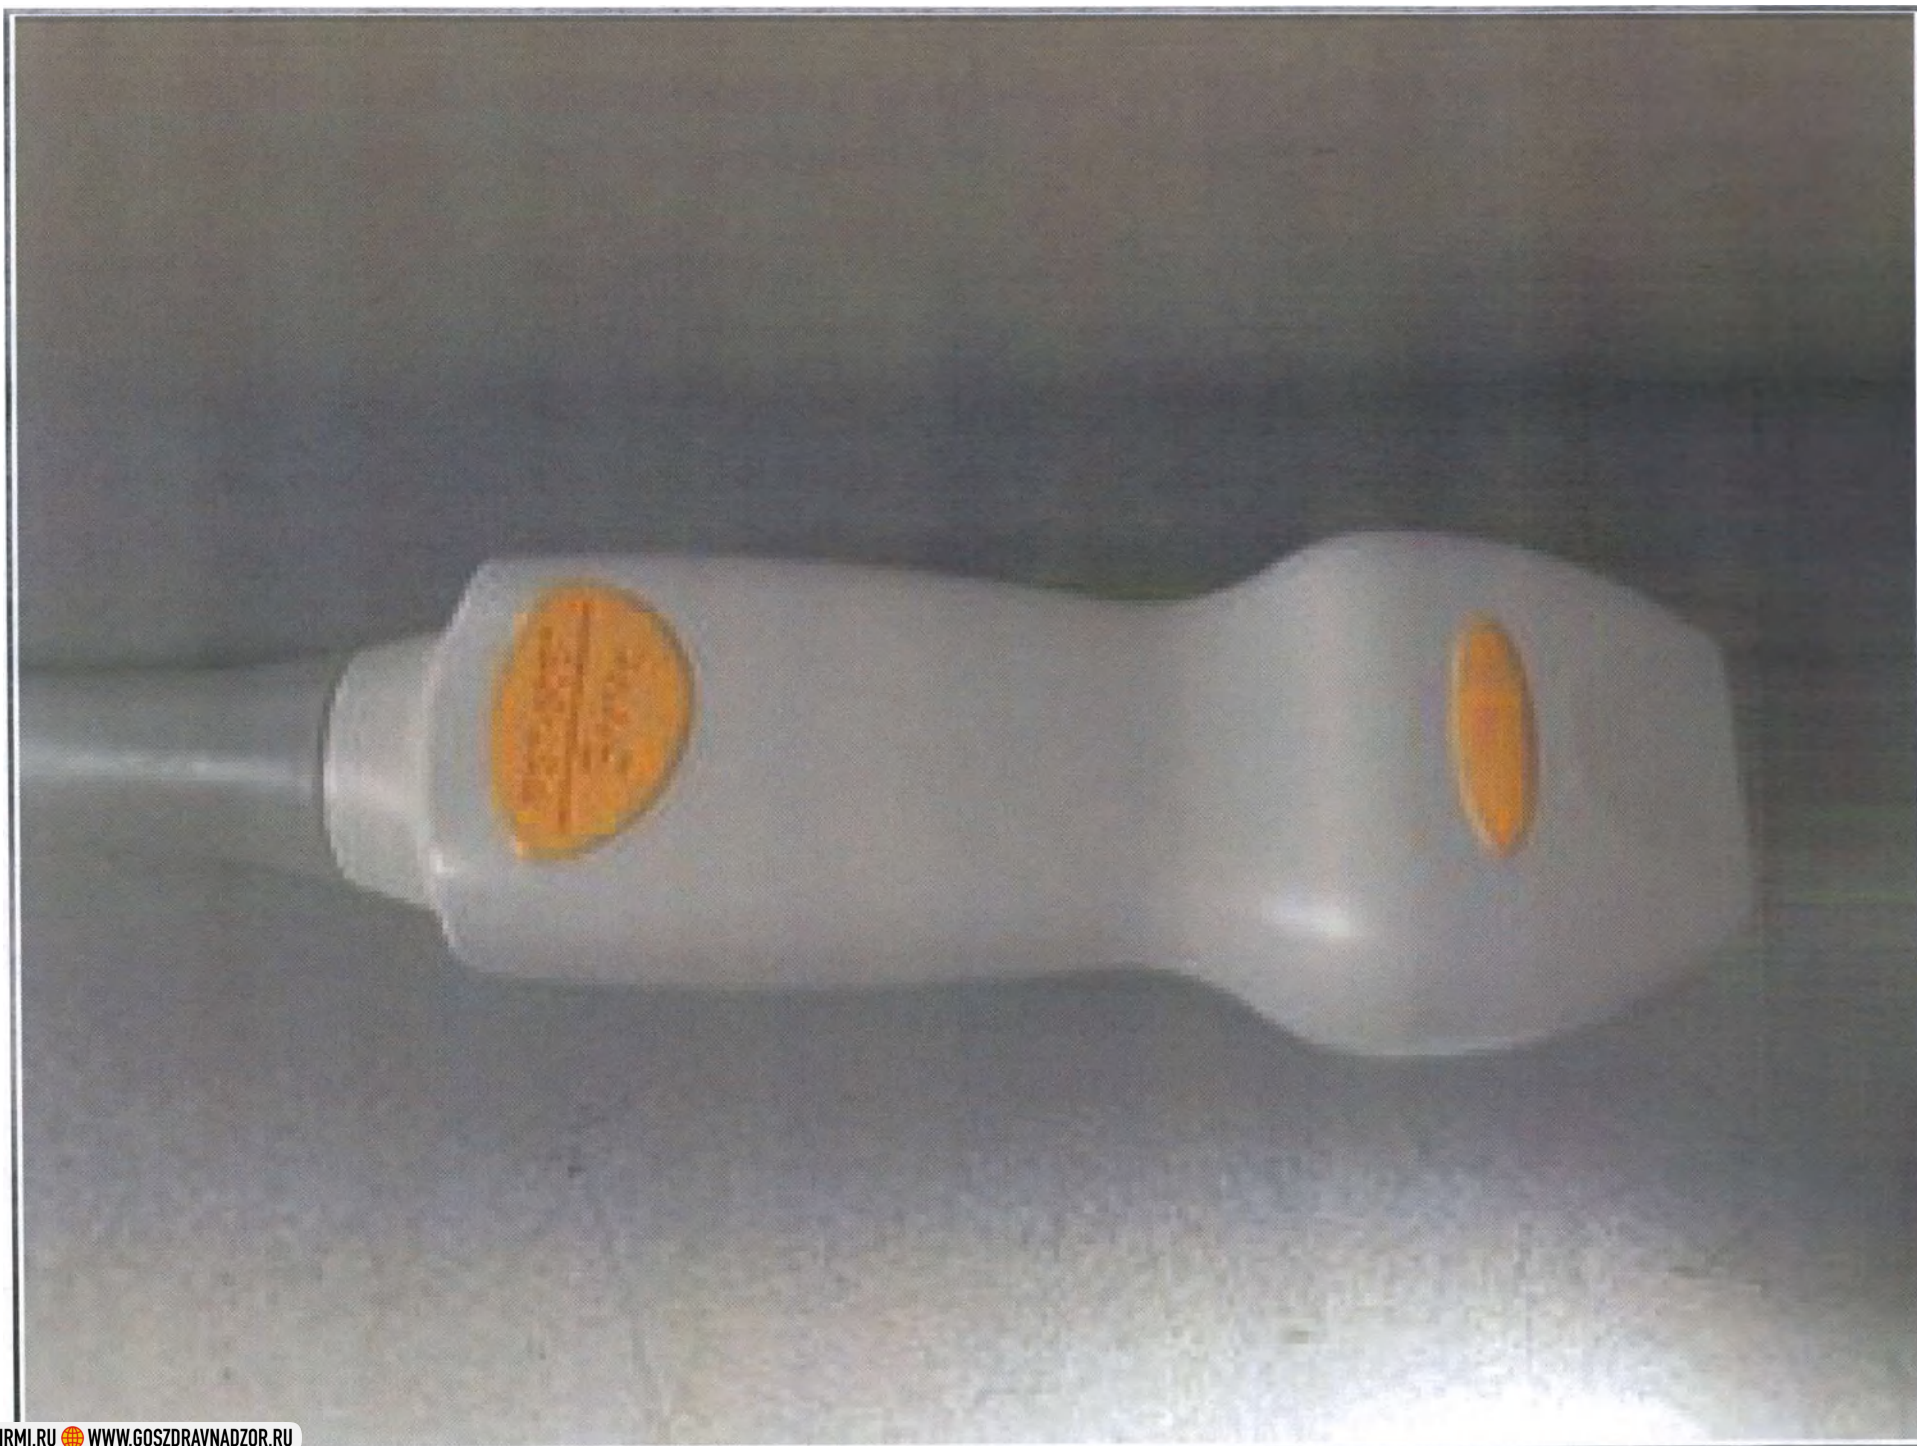




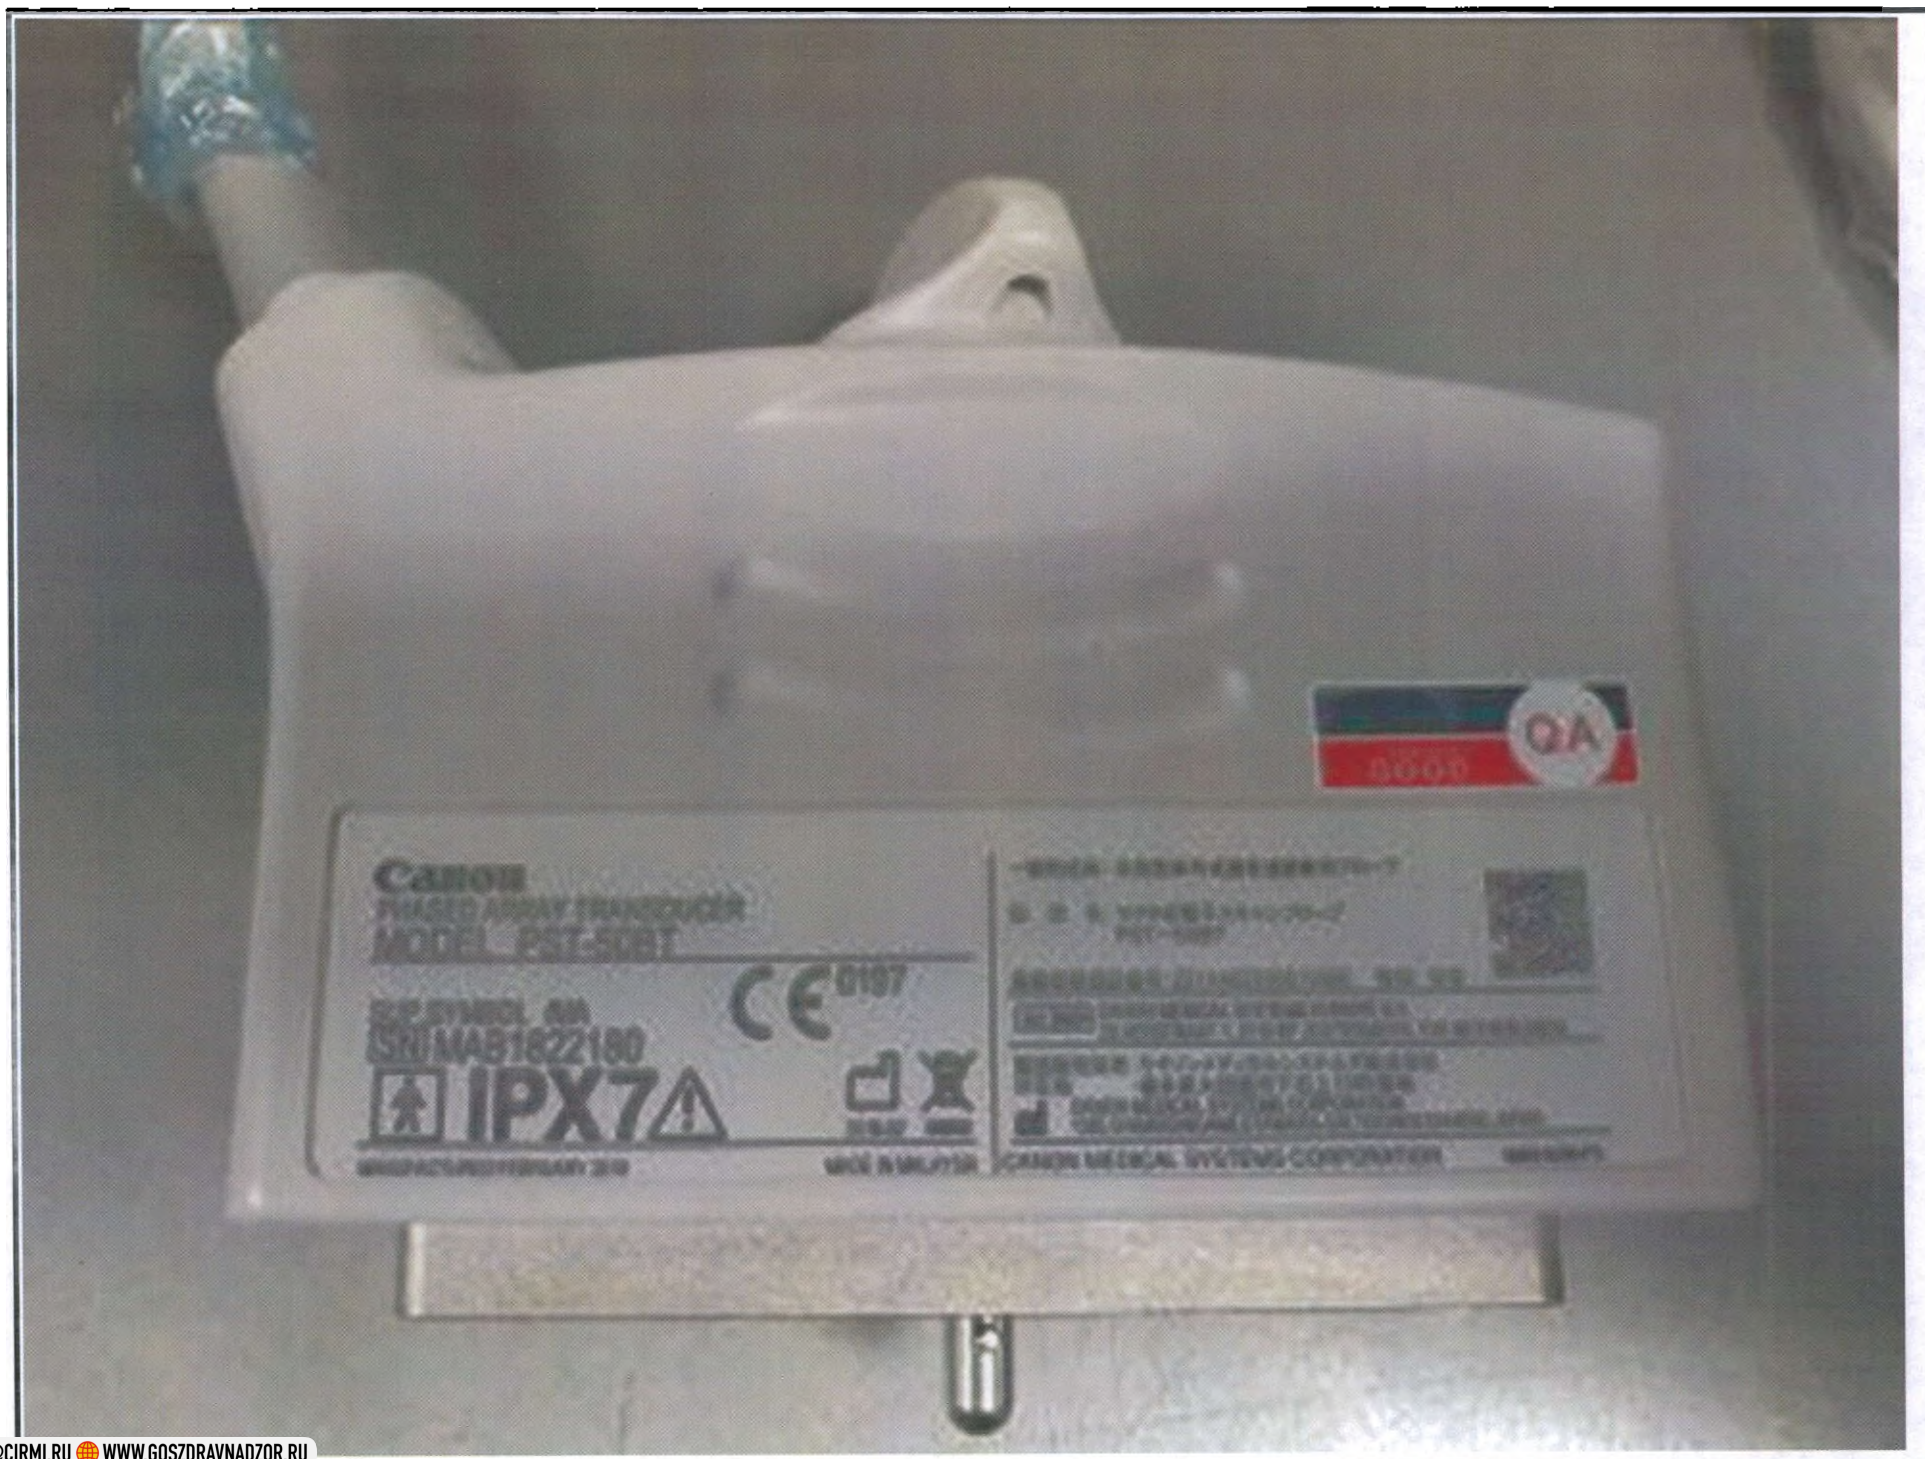



7. Датчик секторный, модель PSI-70BT, производства Canon Medical Systems Corporation, Япония, РУ № РЗН 2020/11544 (при необходимости)

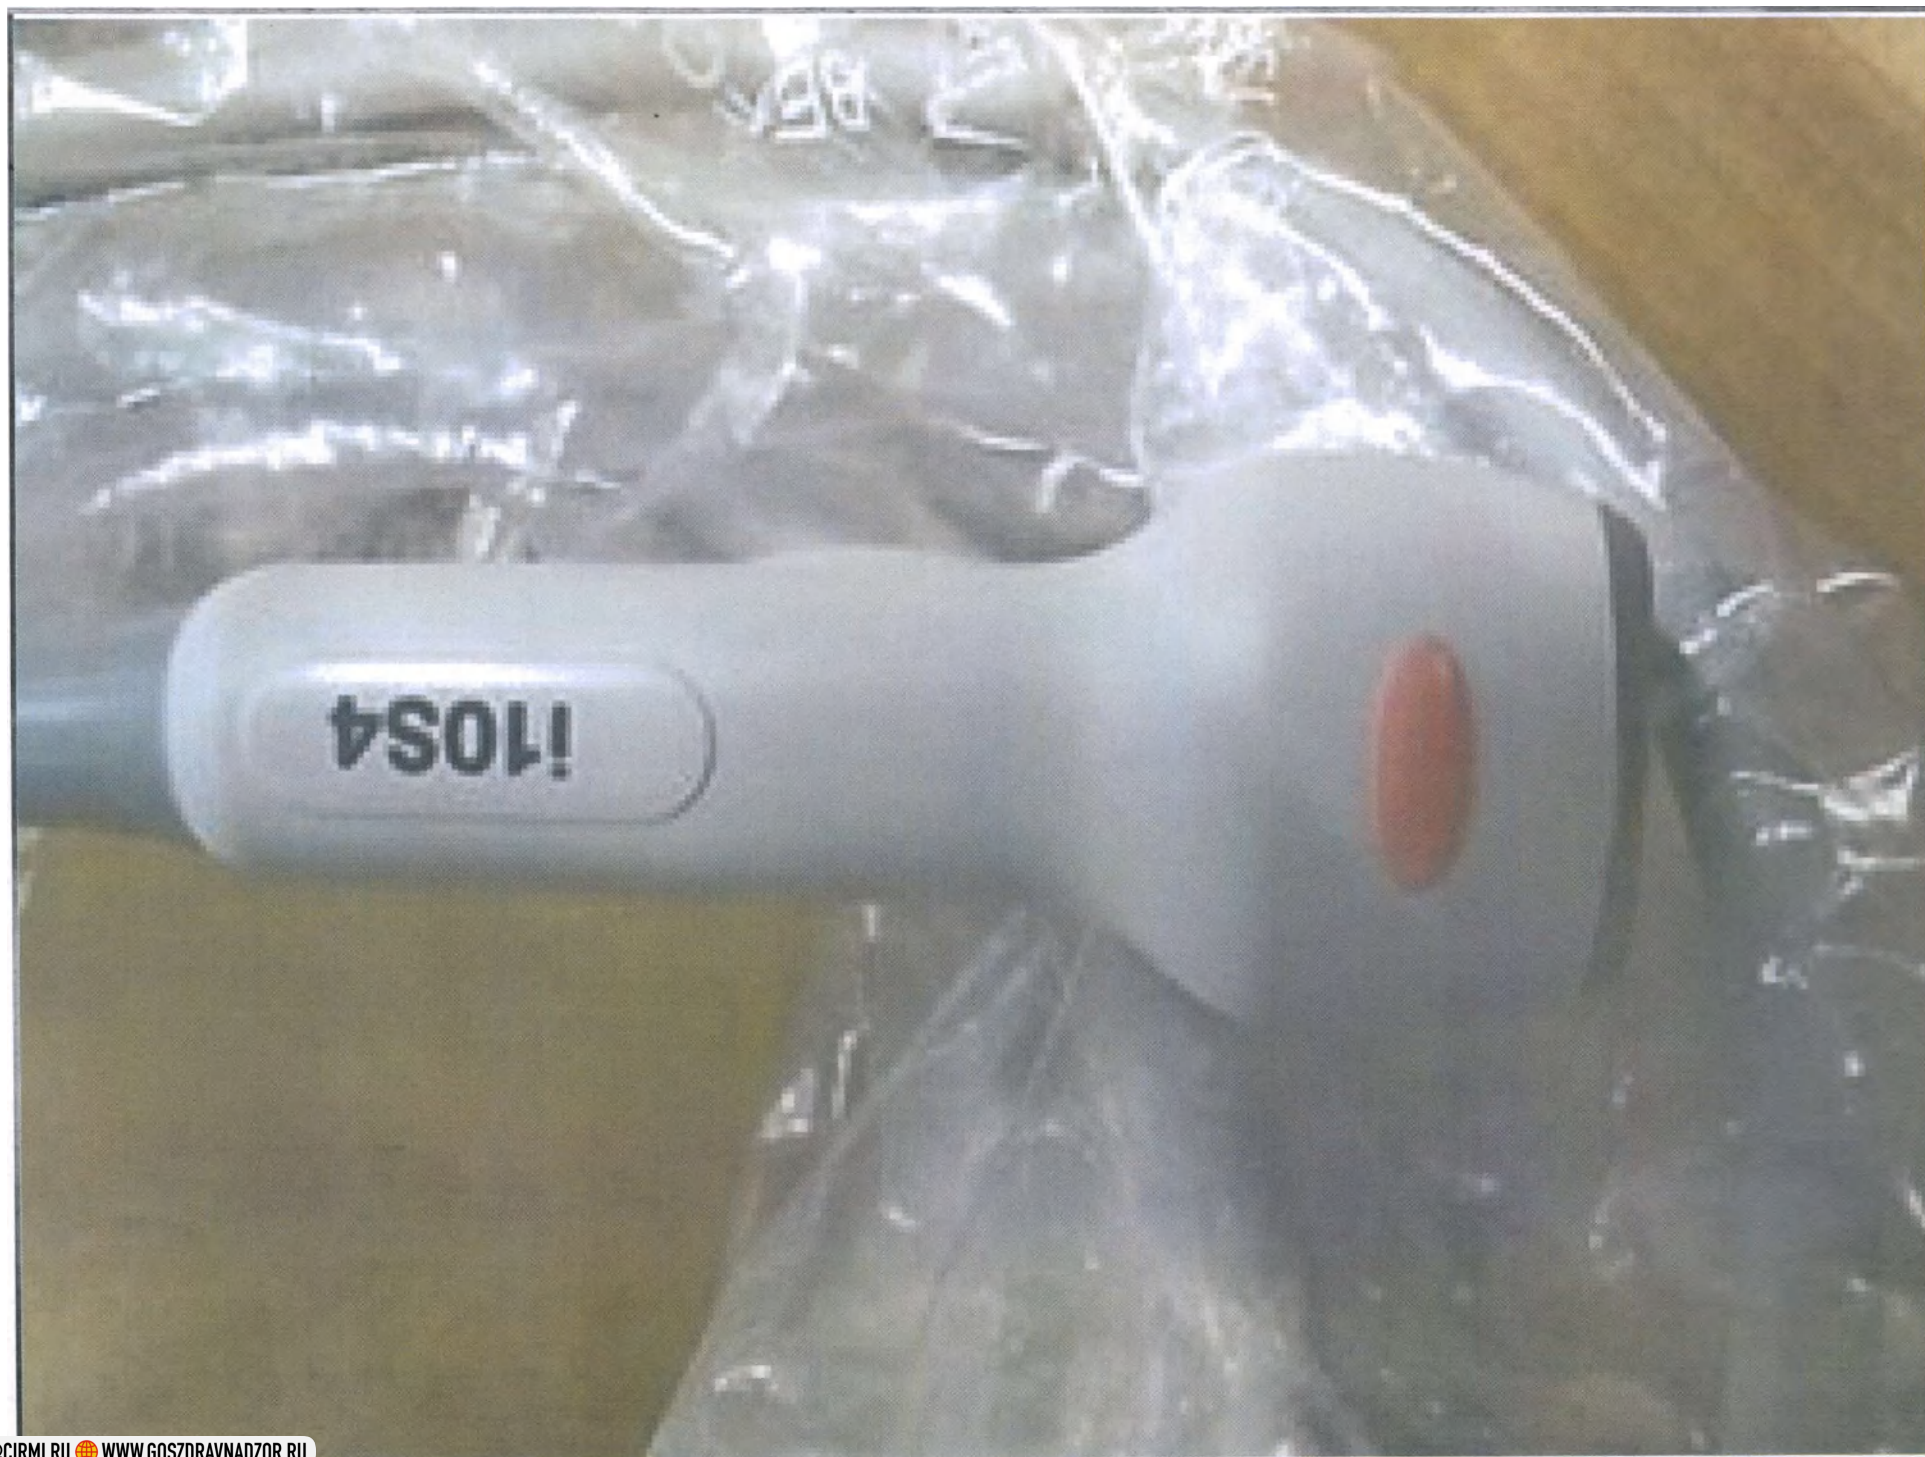



7. Датчик секторный, модель PSI-70BT, производства Canon Medical Systems Corporation, Япония, РУ № РЗН 2020/11544 (при необходимости)





7. Датчик секторный, модель PSI-70BT, производства Canon Medical Systems Corporation, Япония, РУ № P311 2020/11544 (при необходимости)










8. Датчик конвексный биопсийный, модель PVT-350BTP, производства Canon Medical Systems Corporation, Япония, РУ № РЗН 2020/11544 (при необходимости)





8. Датчик конвексный биопсийный, модель PVT-350BTP, производства Canon Medical Systems Corporation, Япония, РУ № РЗП 2020/11544 (при необходимости)

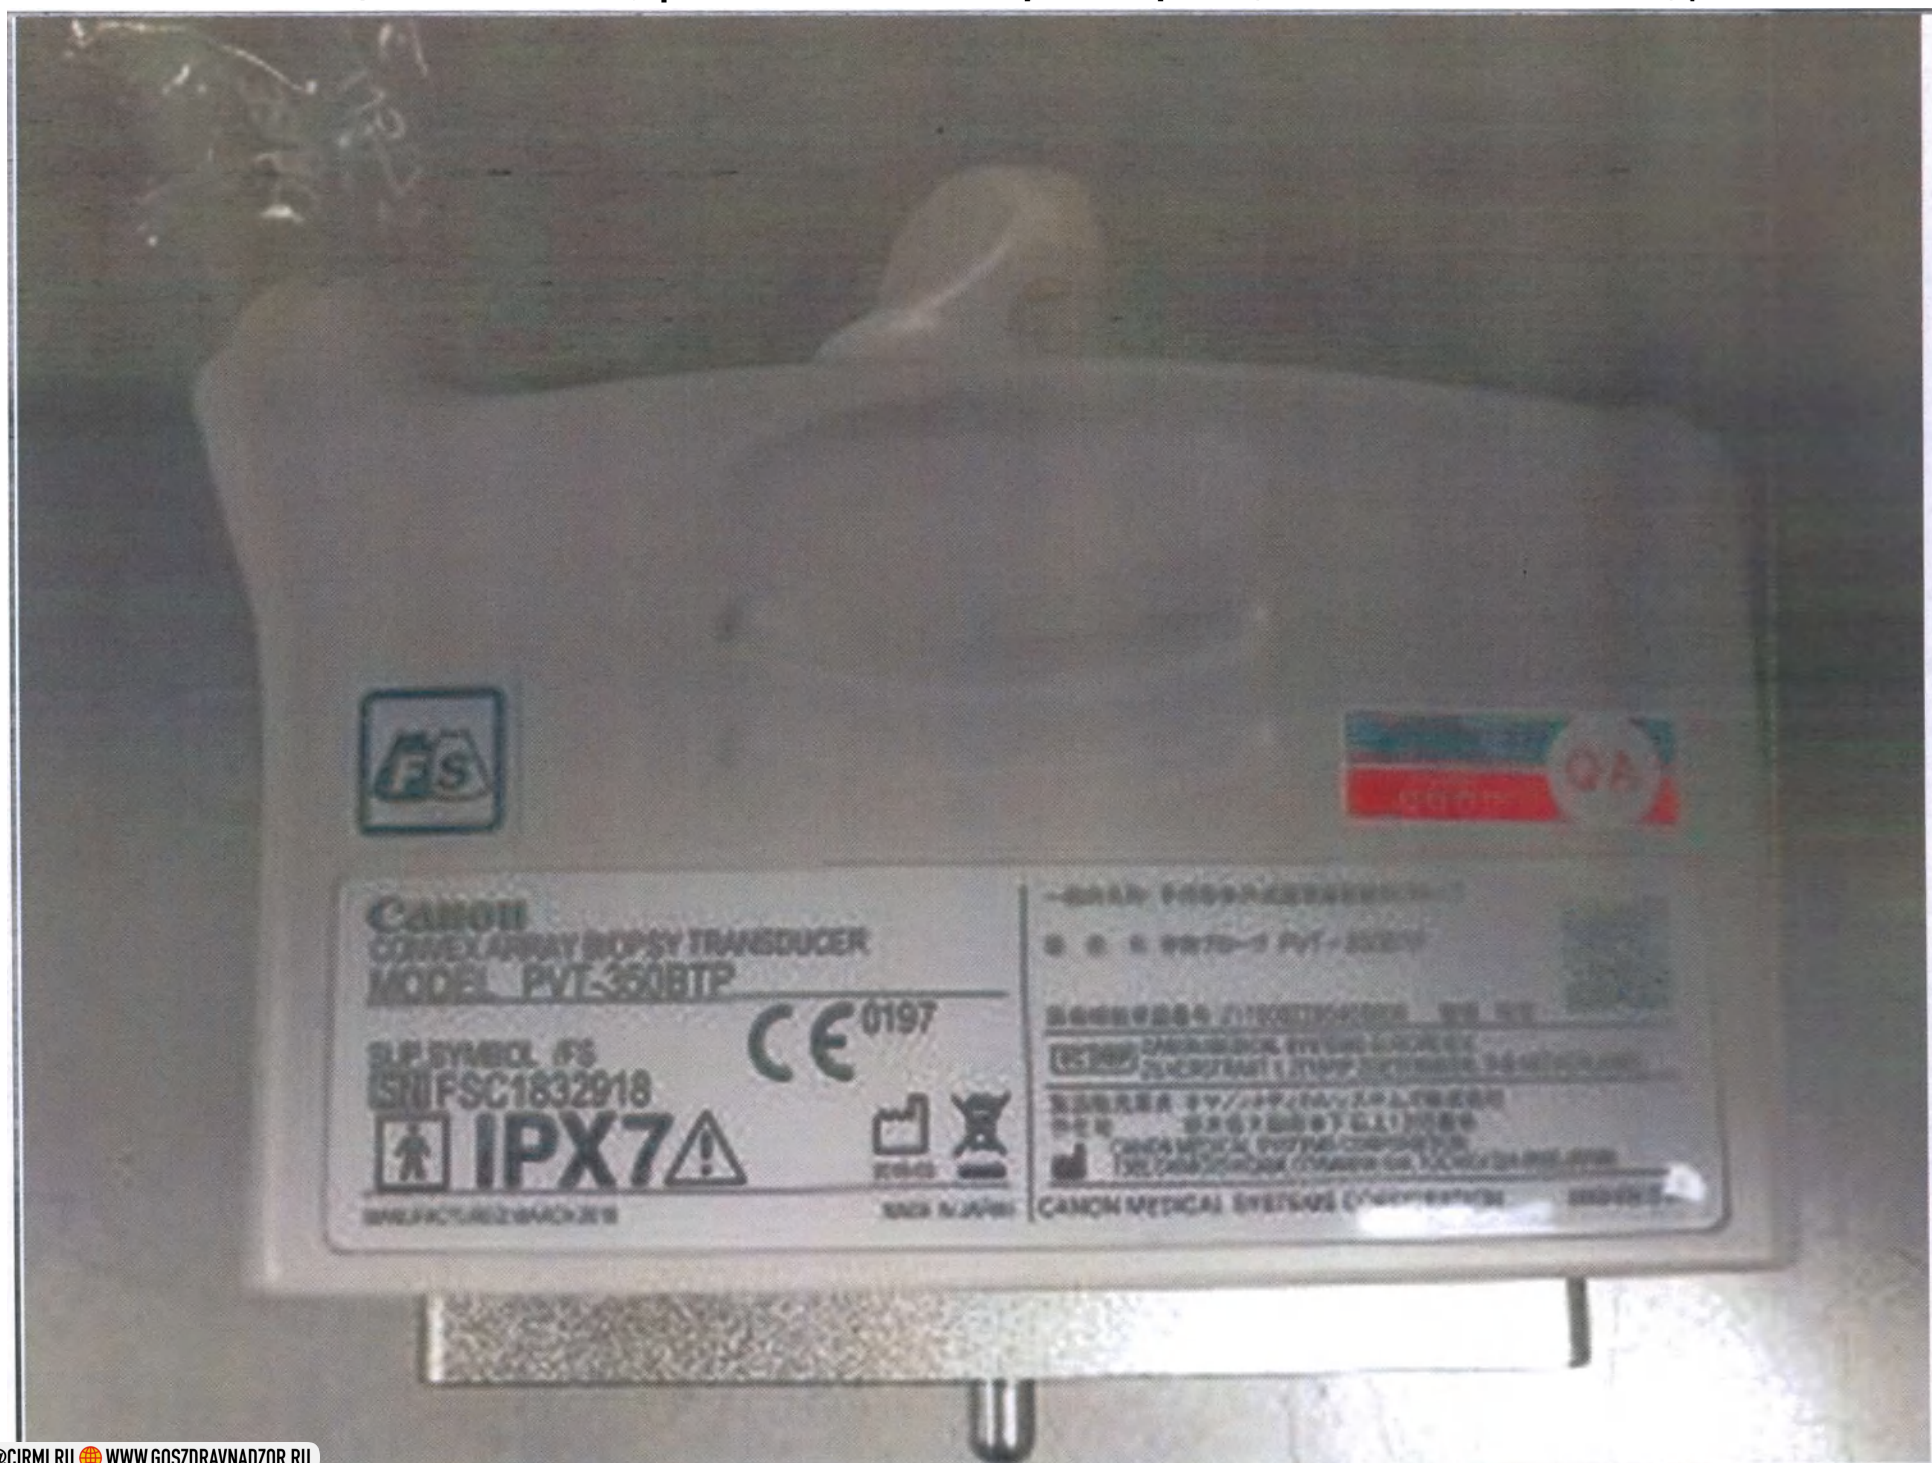



8. Датчик конвексный биопсийный, модель PVT-350BTP, производства Canon Medical Systems Corporation, Япония, РУ № РЗН 2020/11544 (при необходимости)





2. Датчик конвексный, модель PVT-375BT, производства Canon Medical Systems Corporation, Япония, РУ № РЗП 2020/11544 (при необходимости)





9. Датчик конвексный, модель PVT-375BT, производства Canon Medical Systems Corporation, Япония, РУ № P311 2020/11544 (при необходимости)





2. Датчик конвексный, модель PVT-375BT, производства Canon Medical Systems Corporation, Япония, РУ № РЗН 2020/11544 (при необходимости)





10. Датчик конвексный, модель PVT-375SC, производства Canon Medical Systems Corporation, Япония, РУ № РЗН 2020/11544 (при необходимости)






10. Датчик конвексный, модель PVT-375SC, производства Canon Medical Systems Corporation, Япония, РУ № РЗН 2020/11544 (при необходимости)





10. Датчик конвексный, модель PVT-375SC, производства Canon Medical Systems Corporation, Япония, РУ № РЗН 2020/11544 (при необходимости)

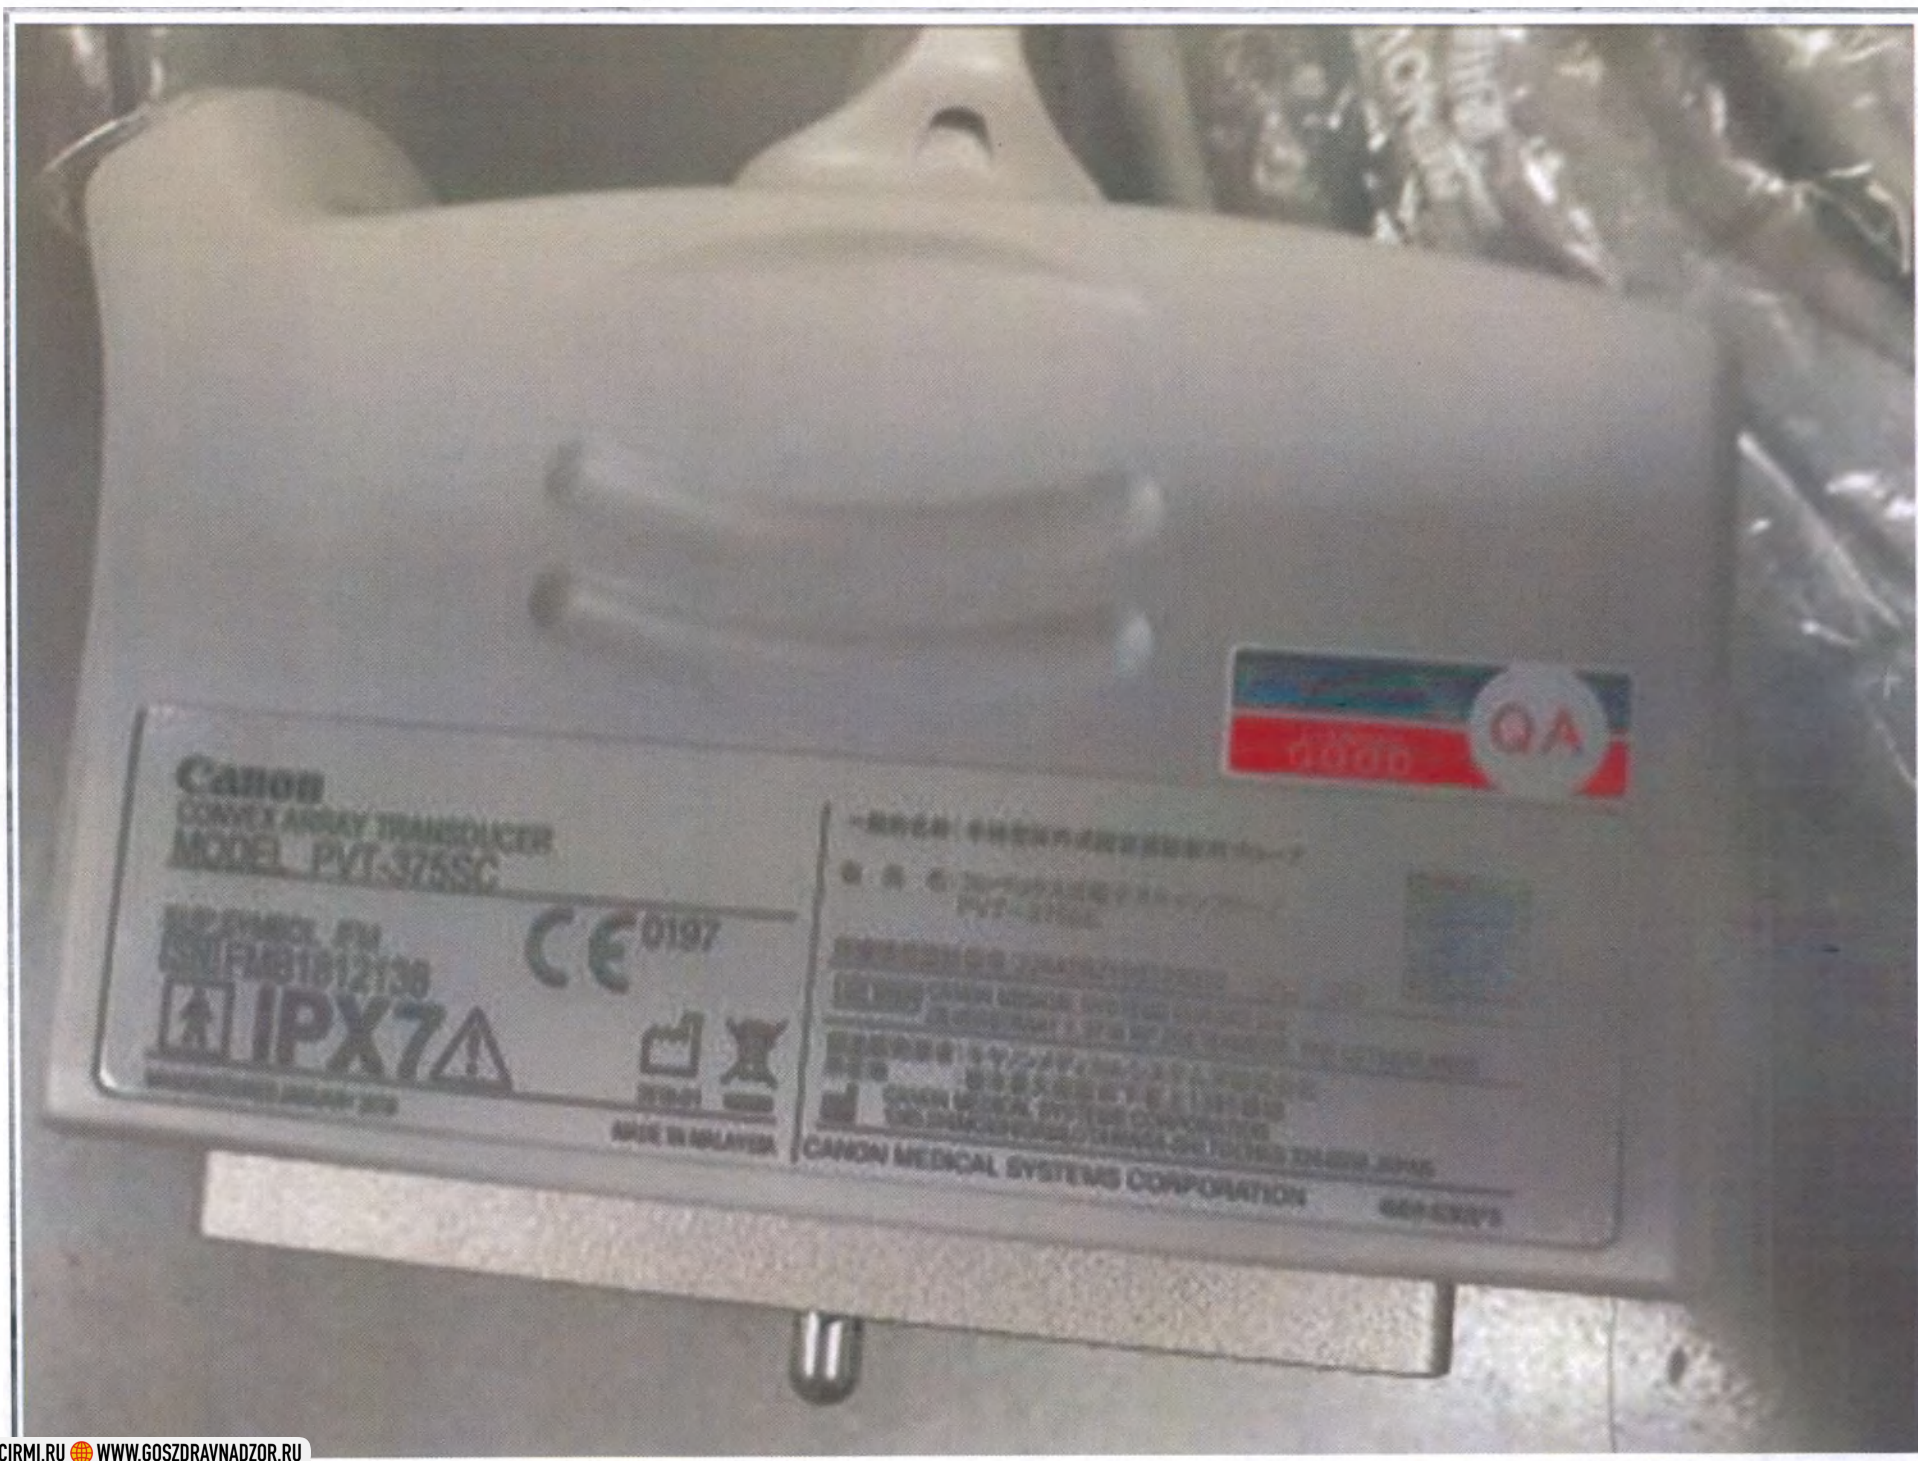




11. Датчик кожно-температурный, модель PVT-382DT, производства Canon Medical Systems Corporation, Япония, РУ № РЗН 2020/11544 (при необходимости)






11. Датчик конвексный, модель PVT-382PT, производства Canon Medical Systems Corporation, Япония, РУ № РЗН 2020/11544 (при необходимости)

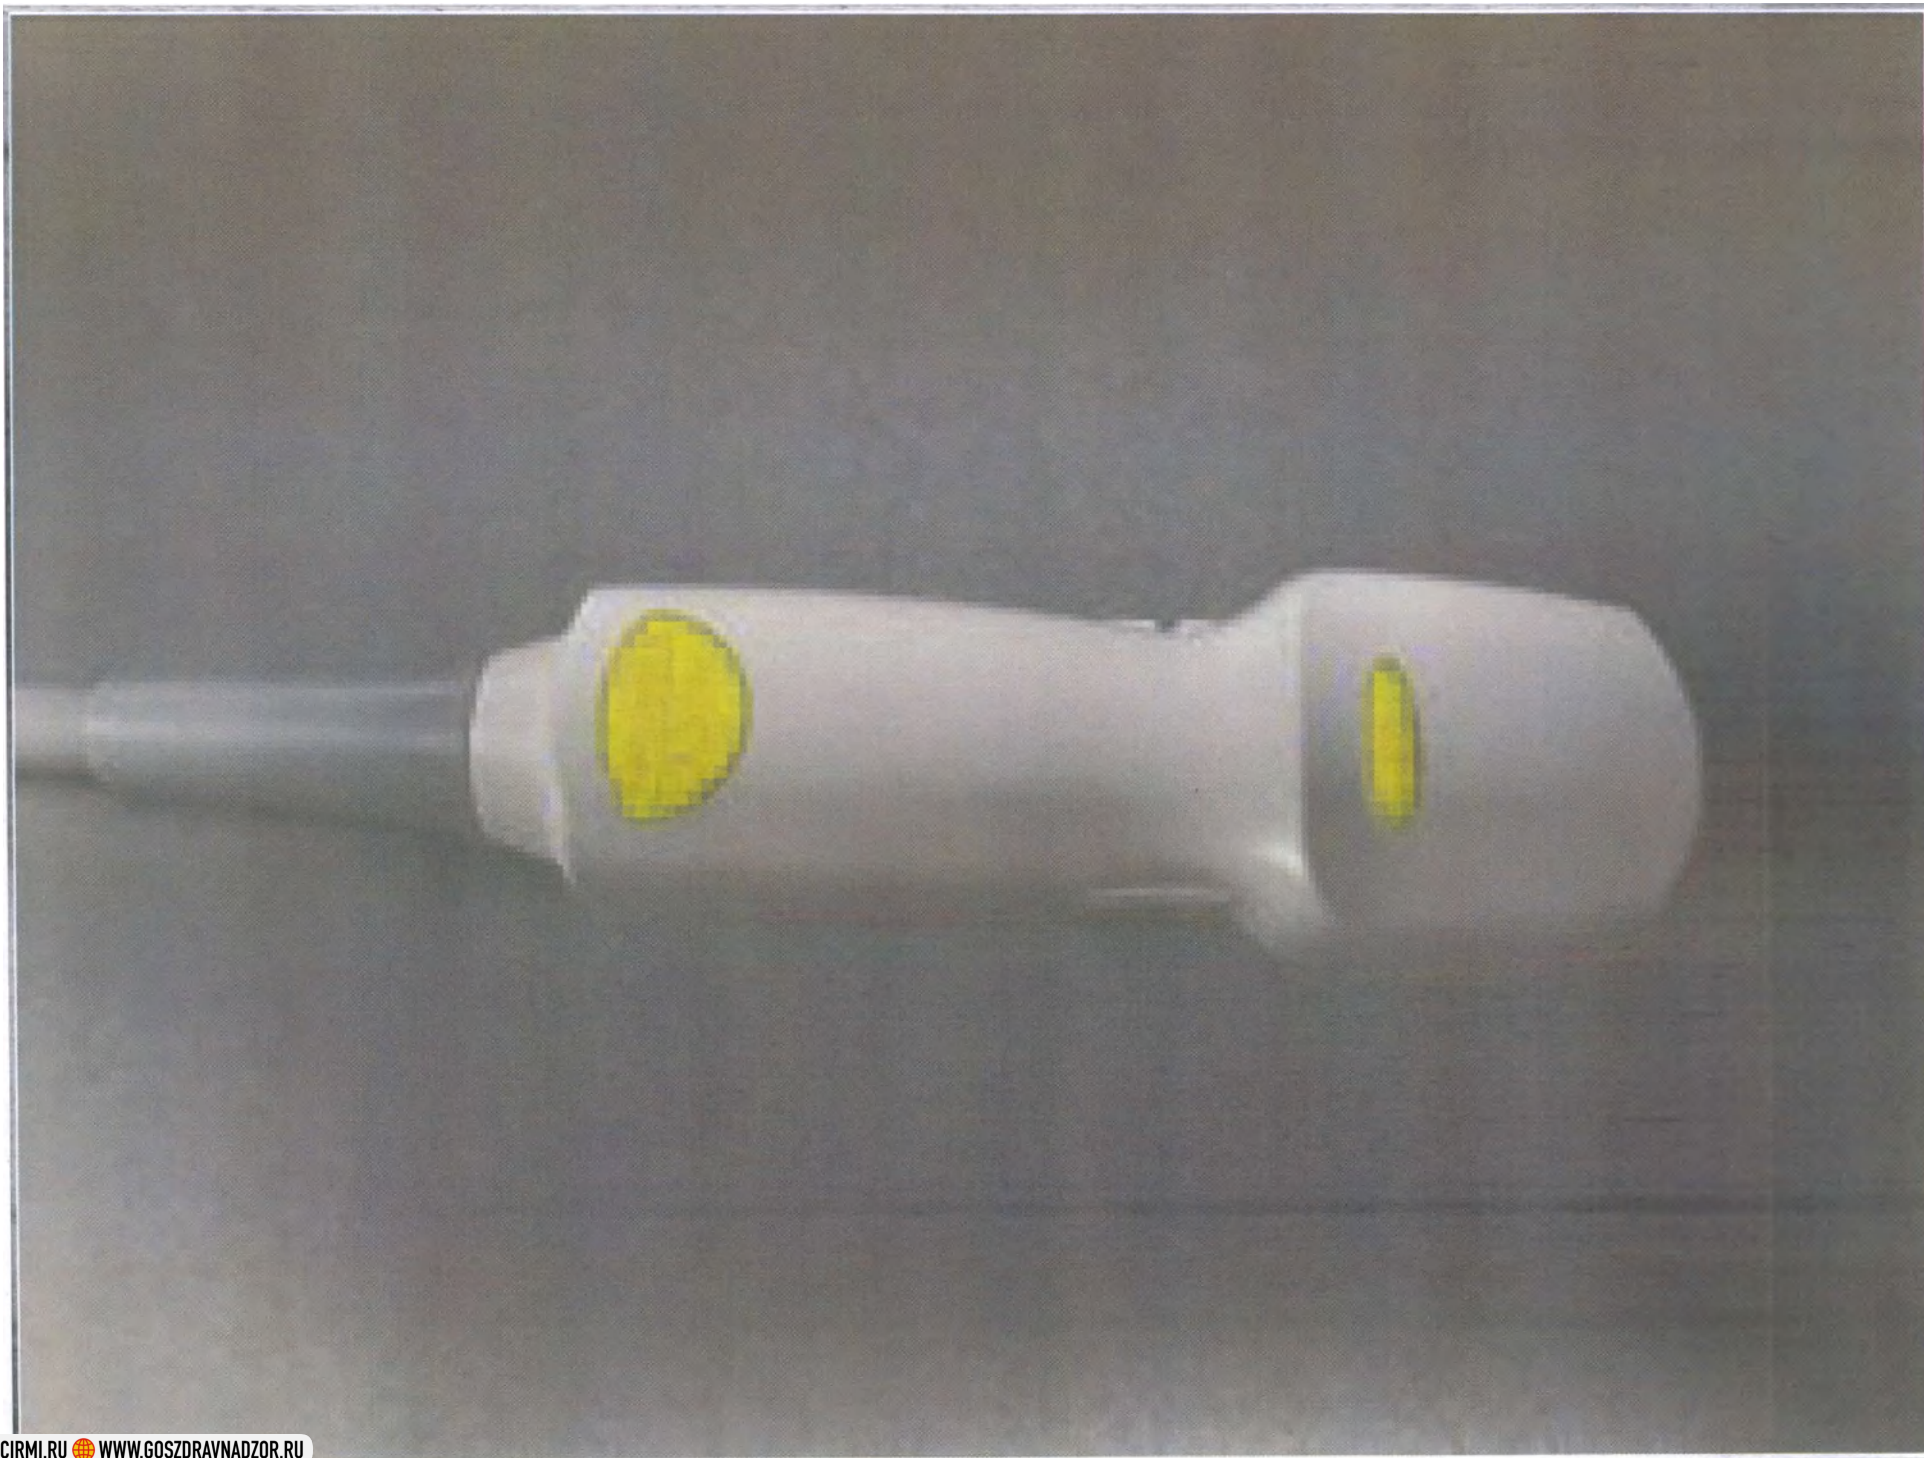




11 Датчик инфракрасный, модель PVT-382BT, произведен Canon Medical Systems Corporation, Япония, РУ № РЗН 2020/11544 (при необходимости)

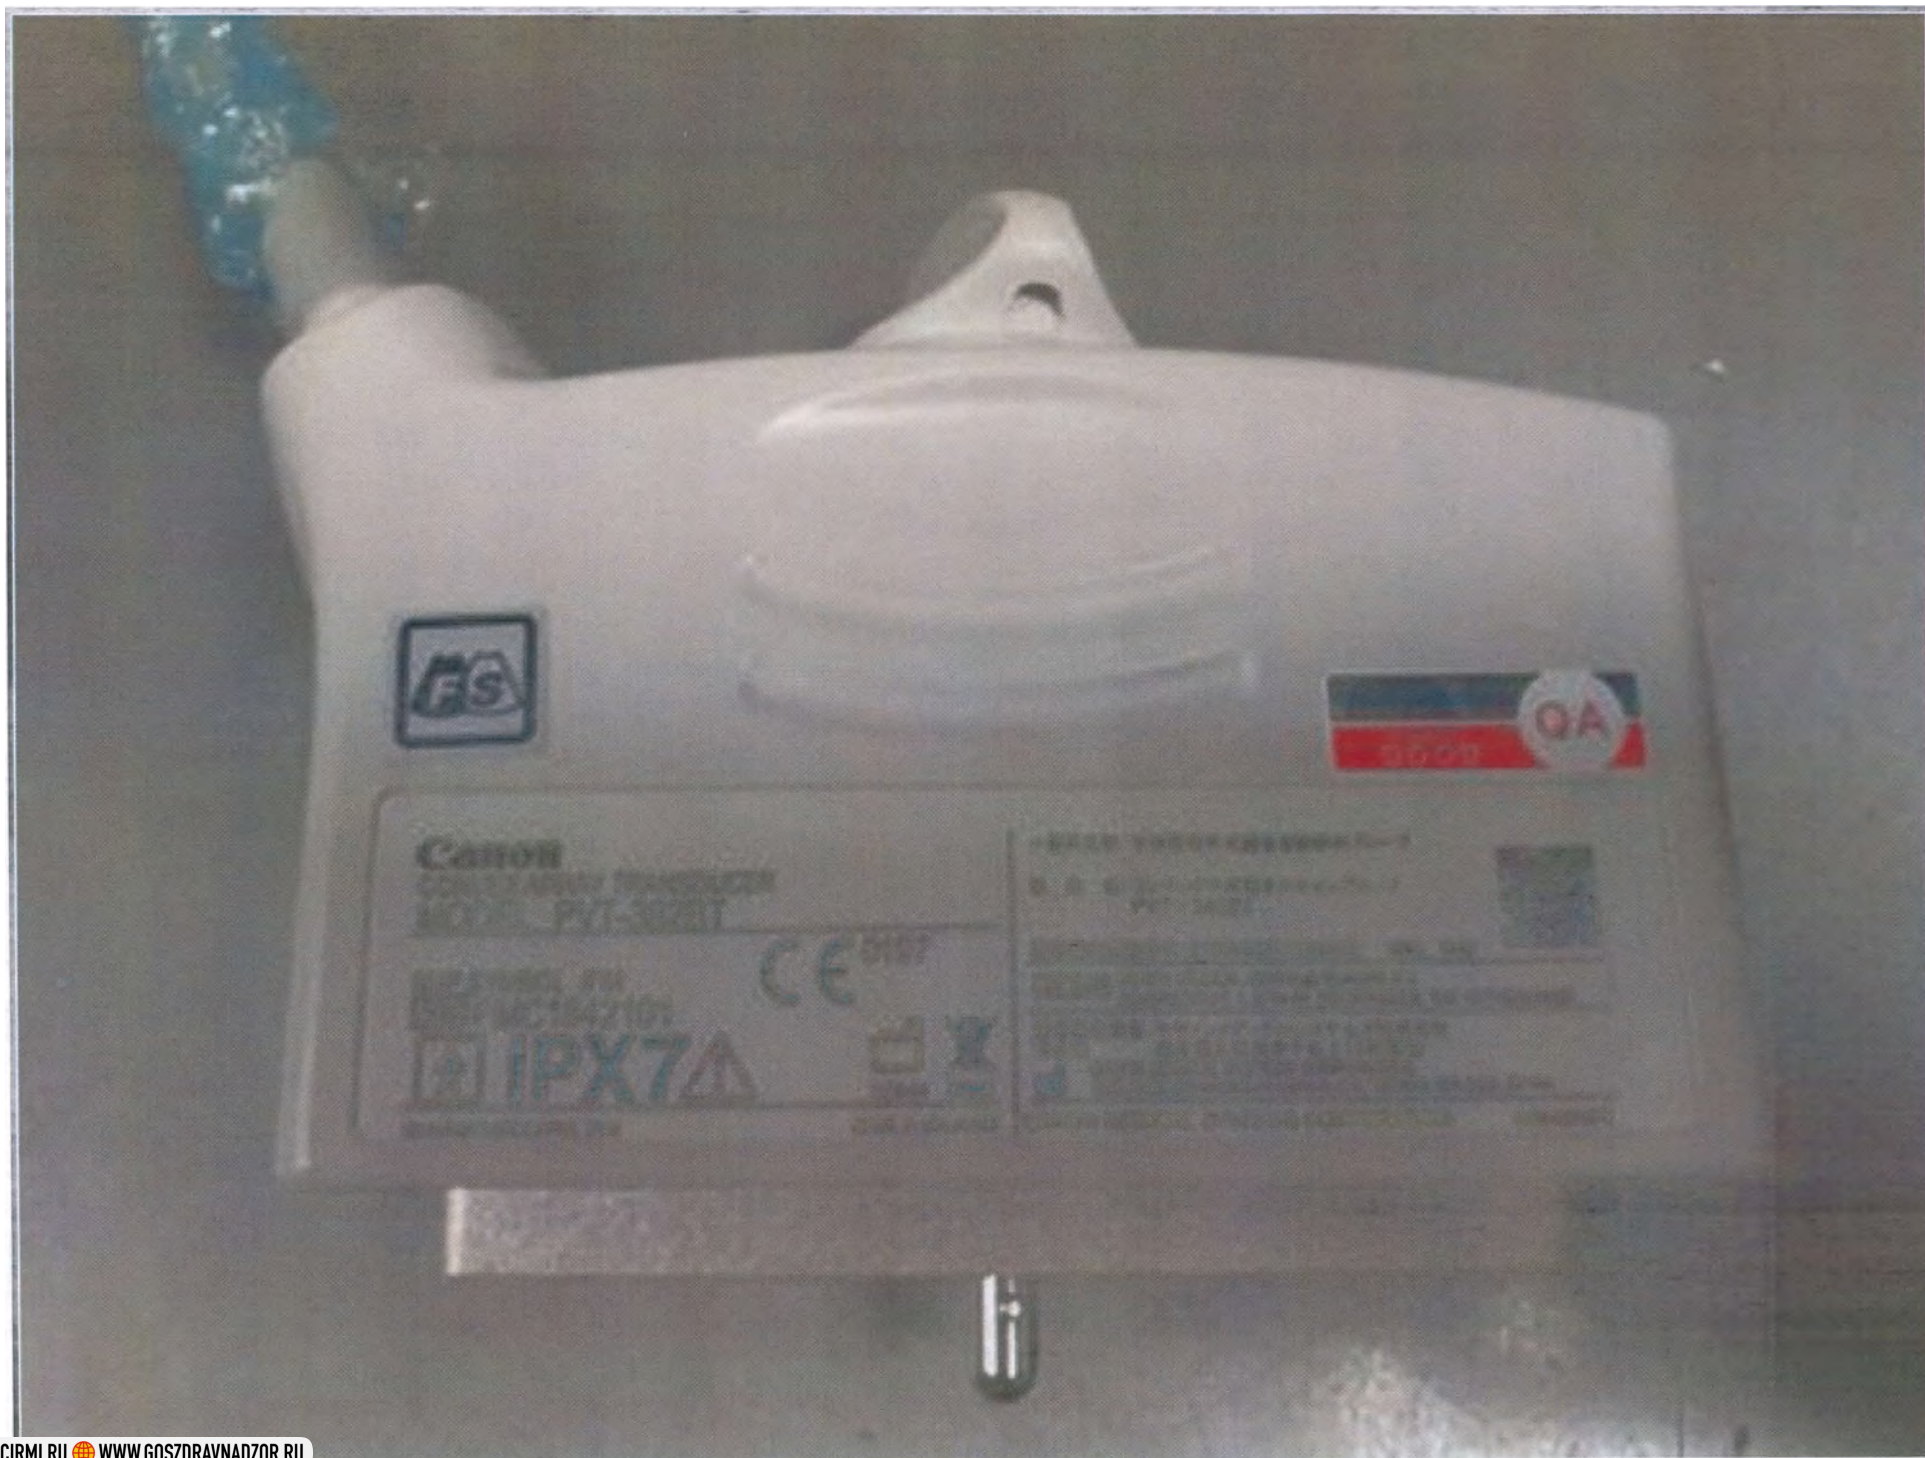



12 Датчик температуры, модель PVT-182PT, производится Canon Medical Systems Corporation, Япония, РУ № РЗН 2020/11544 (при необходимости)

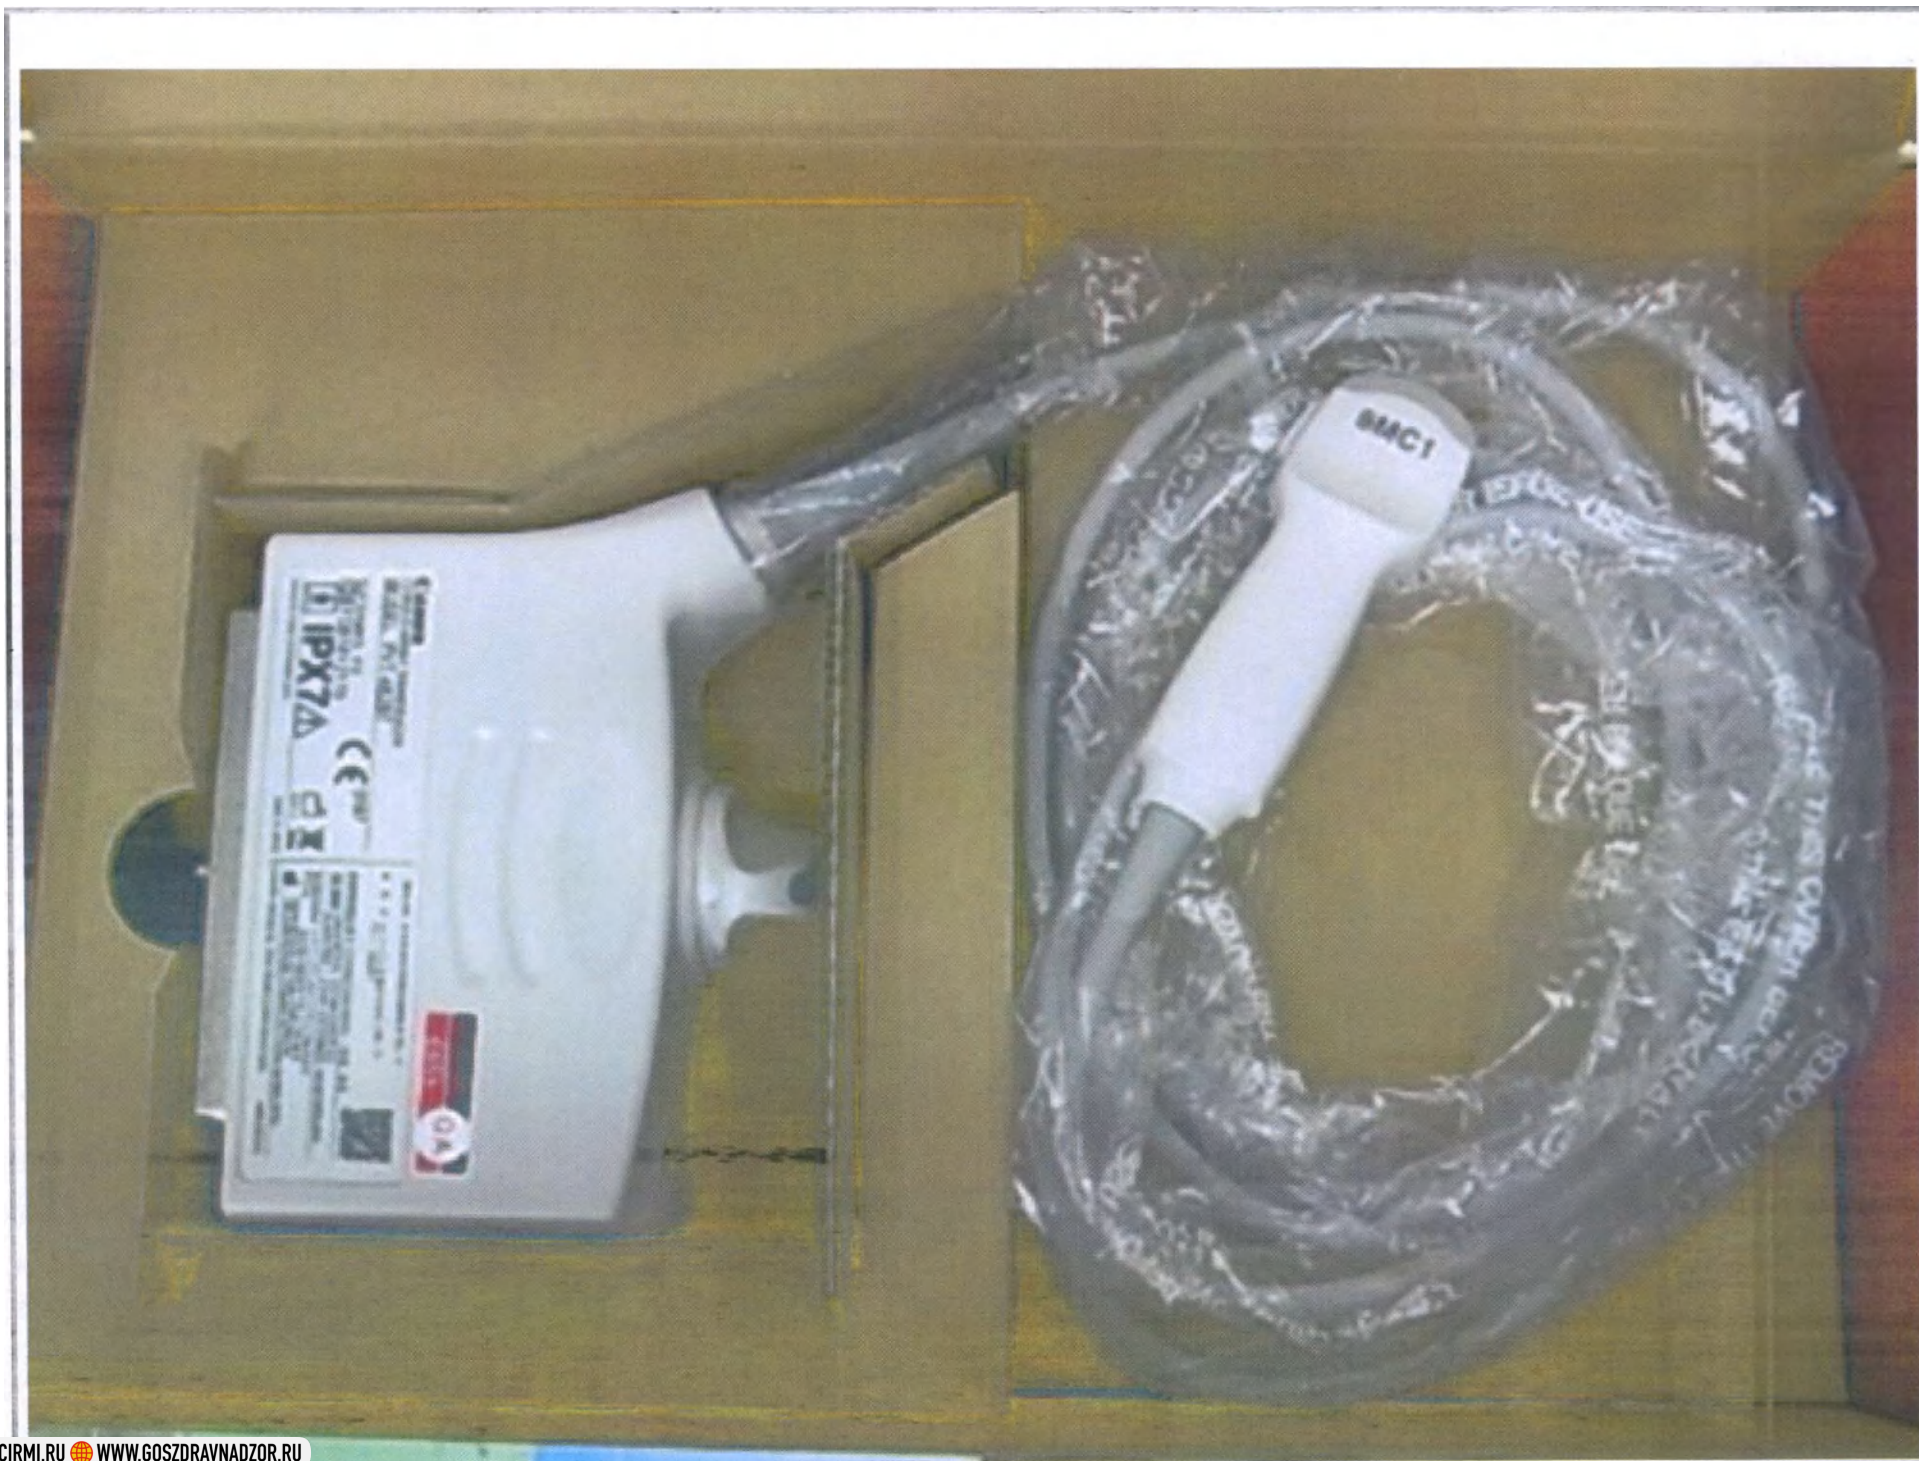







12. Датчик конвексный, модель PVT-482BT, производства Canon Medical Systems Corporation, Япония, РУ № РЗН 2020/11544 (при необходимости)





13. Датчик конвексный, модель PVT-475BT (при необходимости)





## 13. Датчик конвексный, модель PVT-475BT (при необходимости)






## 13. Датчик конвексный, модель PVT-475BT (при необходимости)





14. Датчик конвексный, модель PVT-674BT, производства Canon Medical Systems Corporation, Япония, РУ № РЗН 2020/11544 (при необходимости)

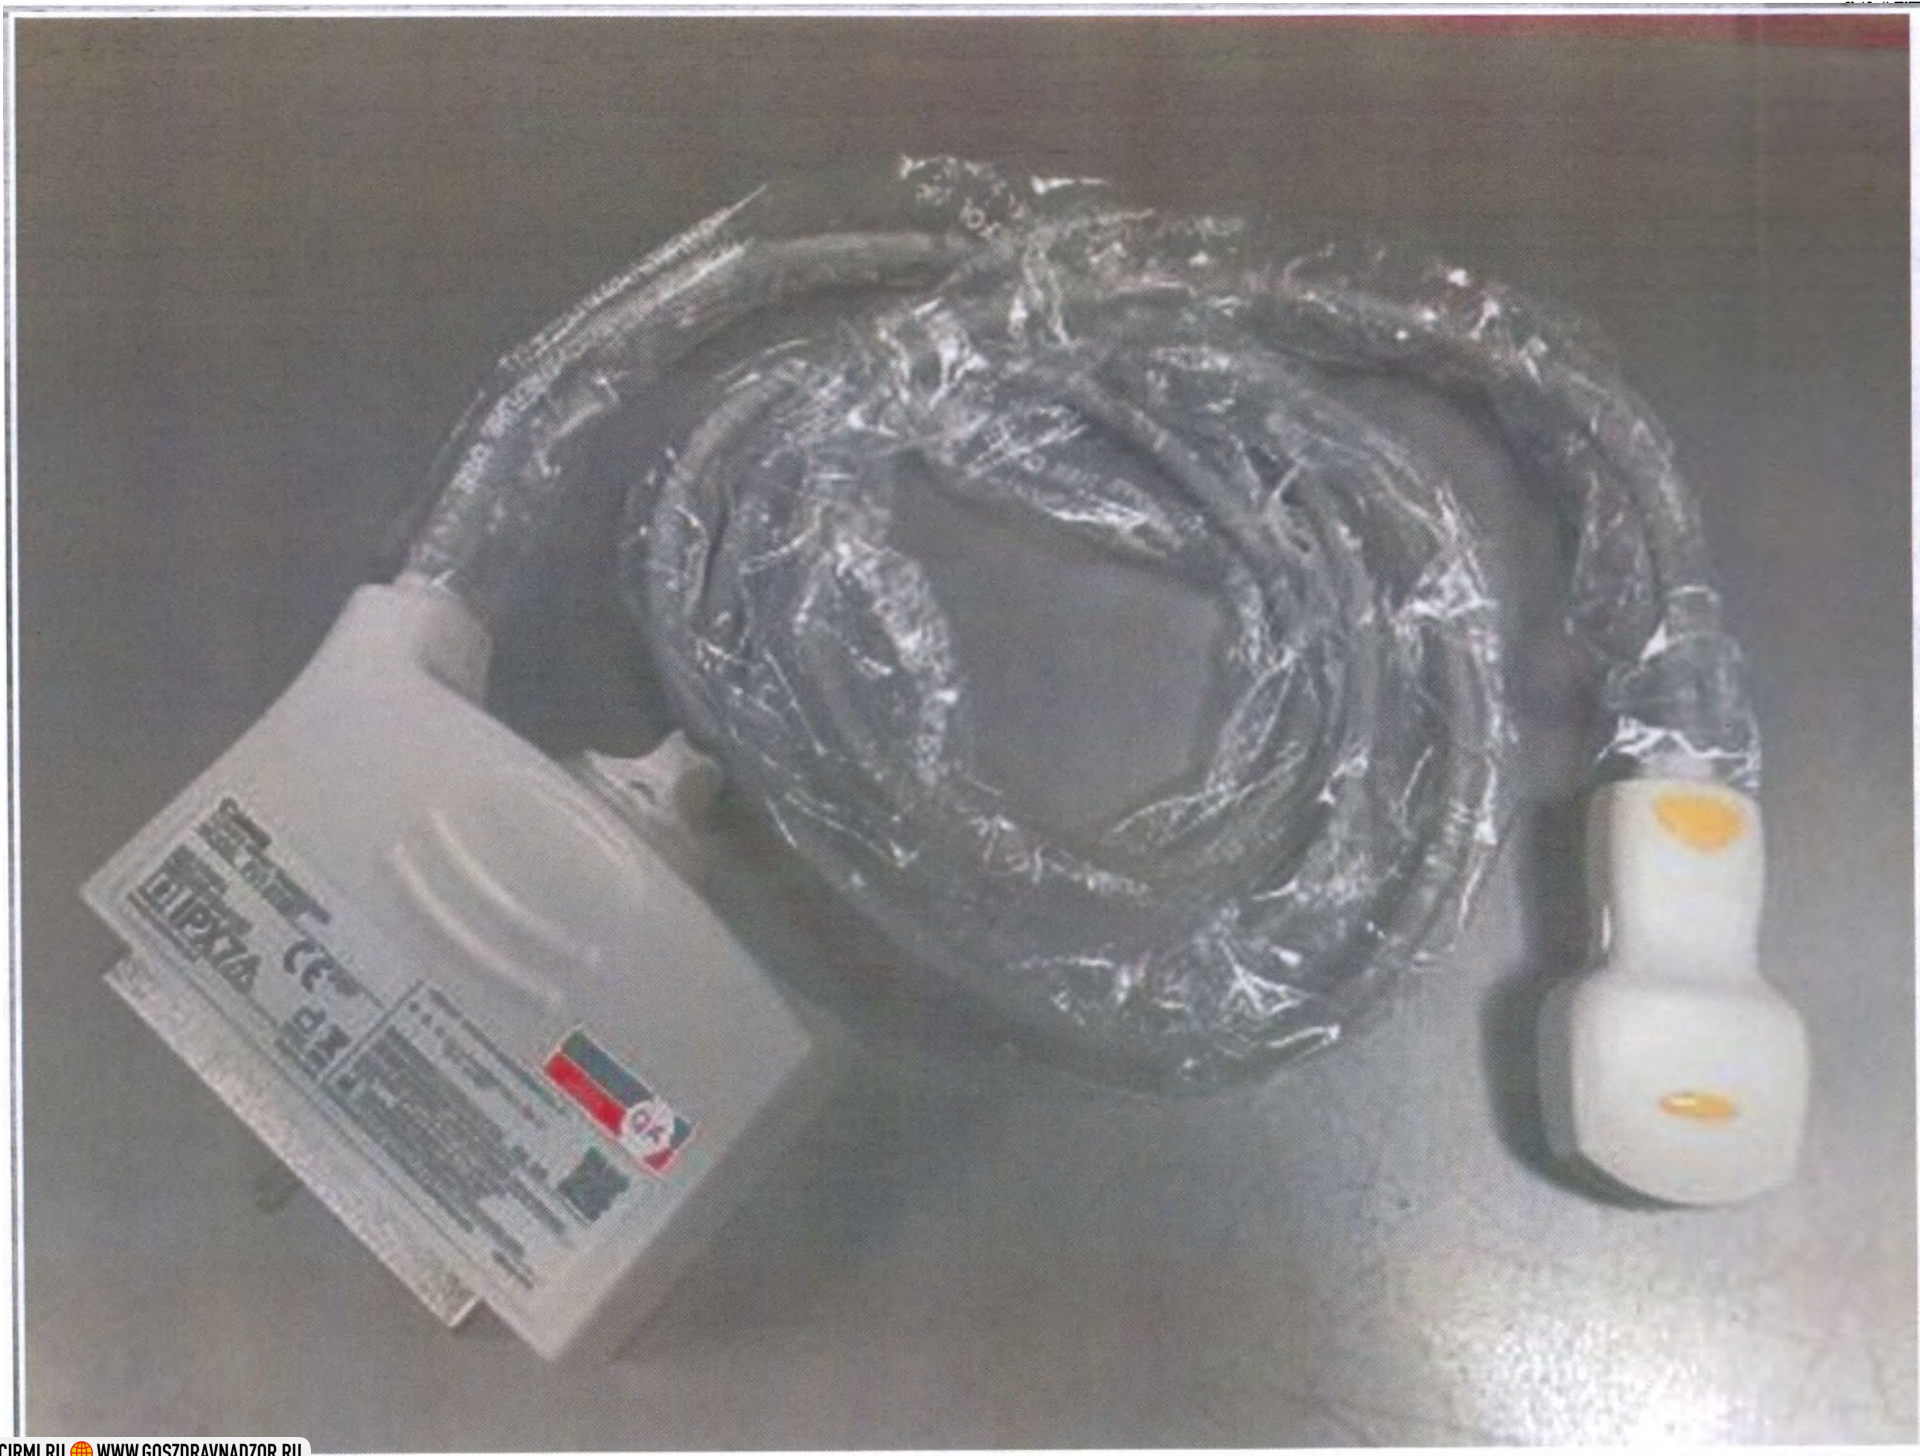



1.4. Датчик ультразвуковой, модель PWT-671BT, производства Canon Medical Systems Corporation, Япония, РУ № РЗН 2020/11544 (при необходимости)





14. Датчик конвексный, модель PVT-674BT, производства Canon Medical Systems Corporation, Япония, РУ № РЗН 2020/11544 (при необходимости)





15. Датчик конвексный, модель PVT-675MVL, производства Canon Medical Systems Corporation, Япония, РУ № РЗН 2020/11544 (при необходимости)






15. Датчик конвексный, модель PVT-675MVL, производства Canon Medical Systems Corporation, Япония, РУ № РЗН 2020/11544 (при необходимости)





15. Датчик конвексный, модель PVT-675MVL, производства Canon Medical Systems Corporation, Япония, РУ № РЗН 2020/11544 (при необходимости)

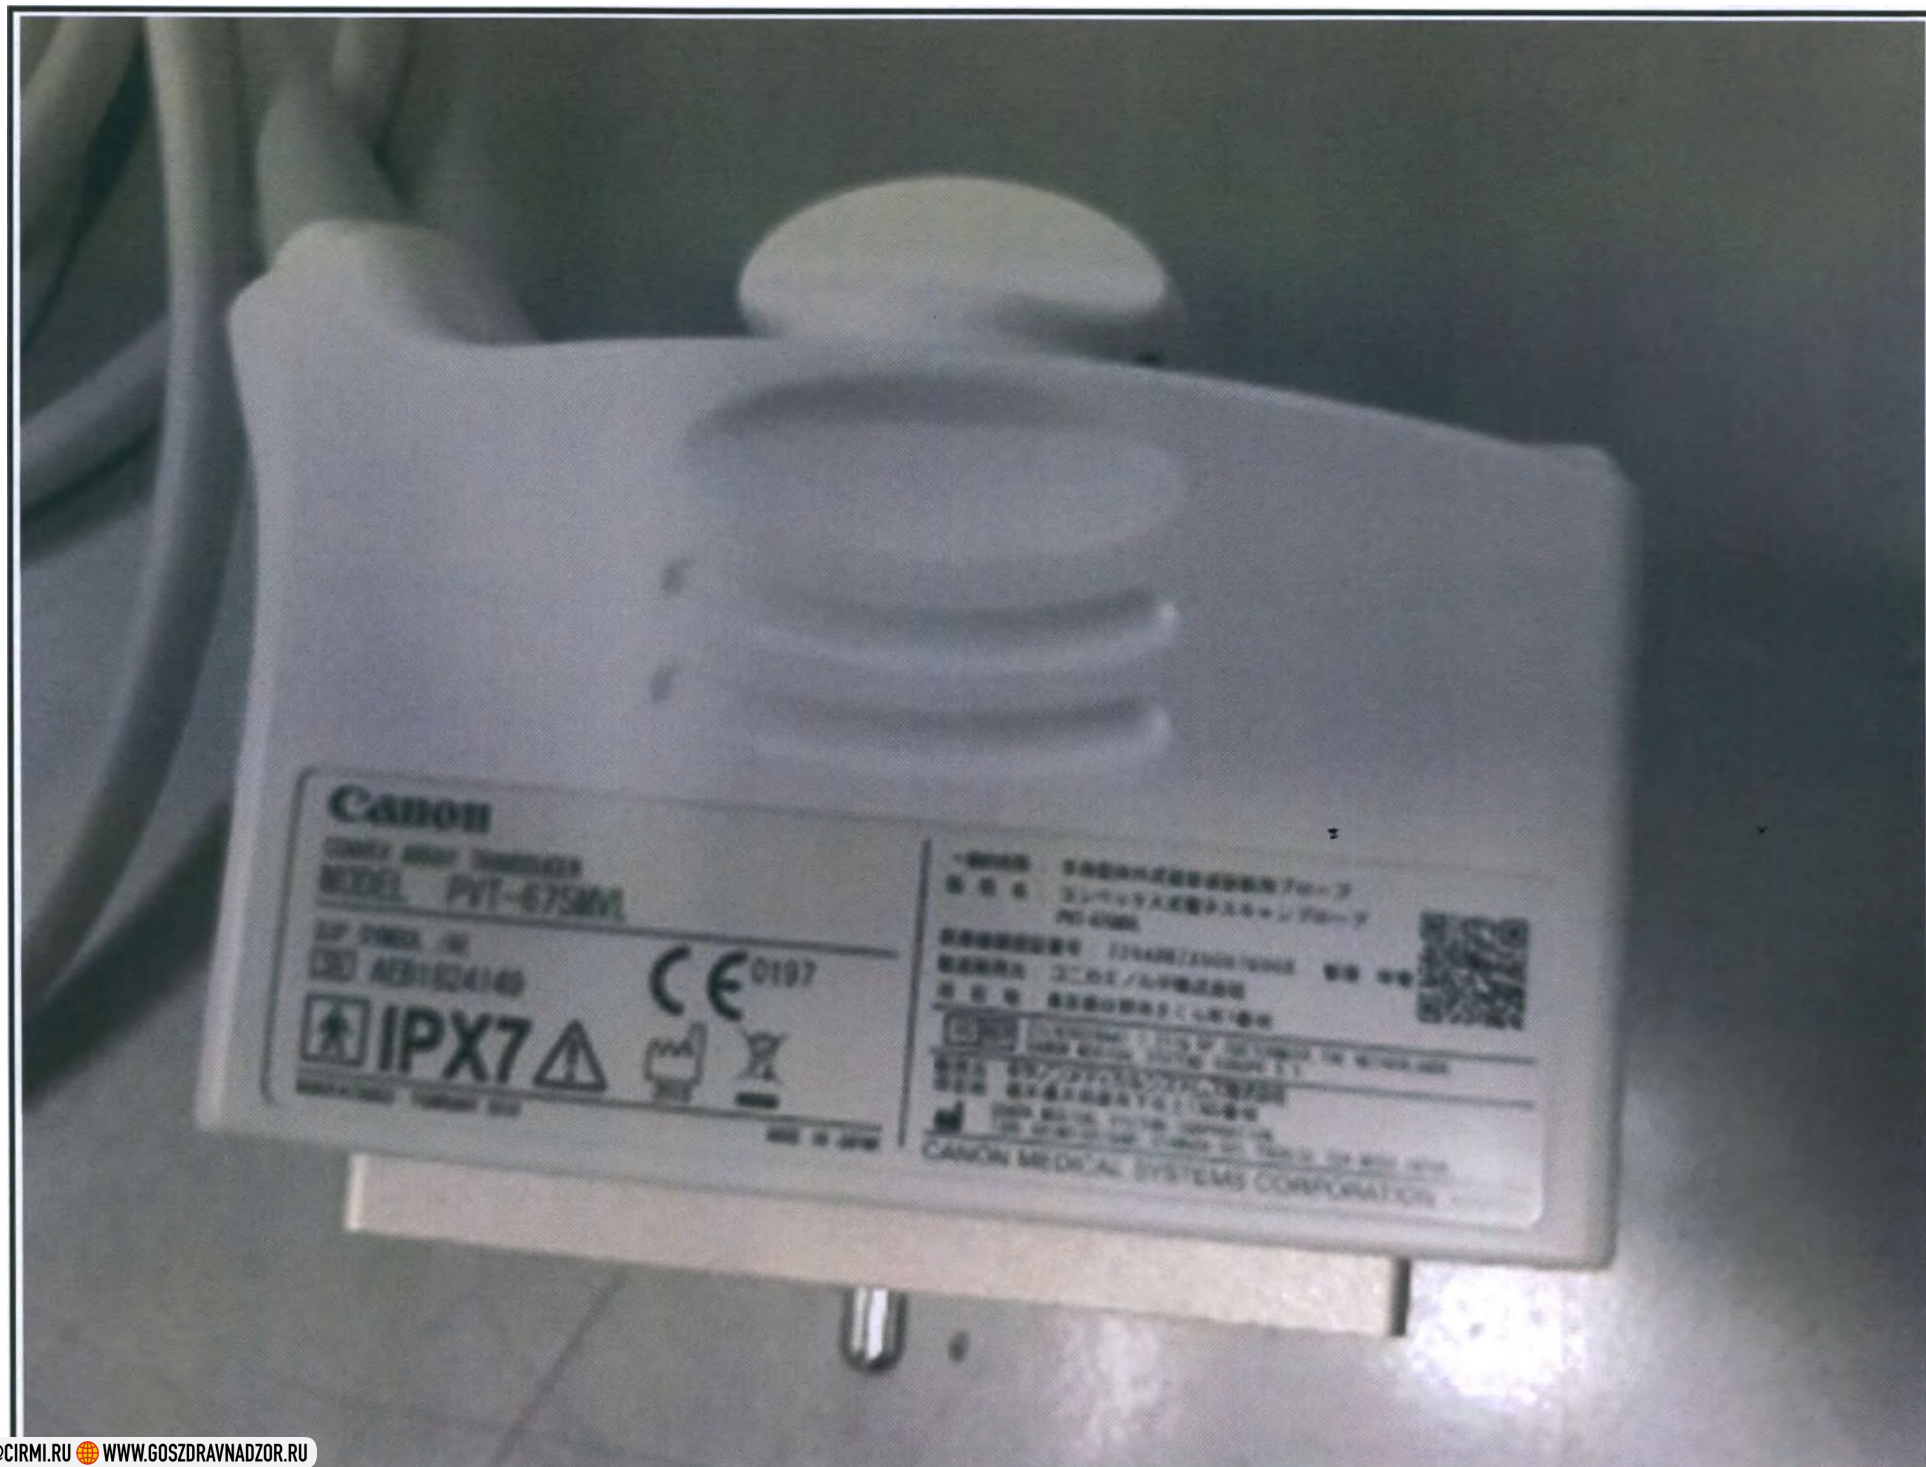




16. Датчик конвексный, модель PVT-675MVS, производства Canon Medical Systems Corporation, Япония, РУ № РЗН 2020/11544 (при необходимости)





16. Датчик конвексный, модель PVT-675MVS, производства Canon Medical Systems Corporation, Япония, РУ № РЗН 2020/11544 (при необходимости)

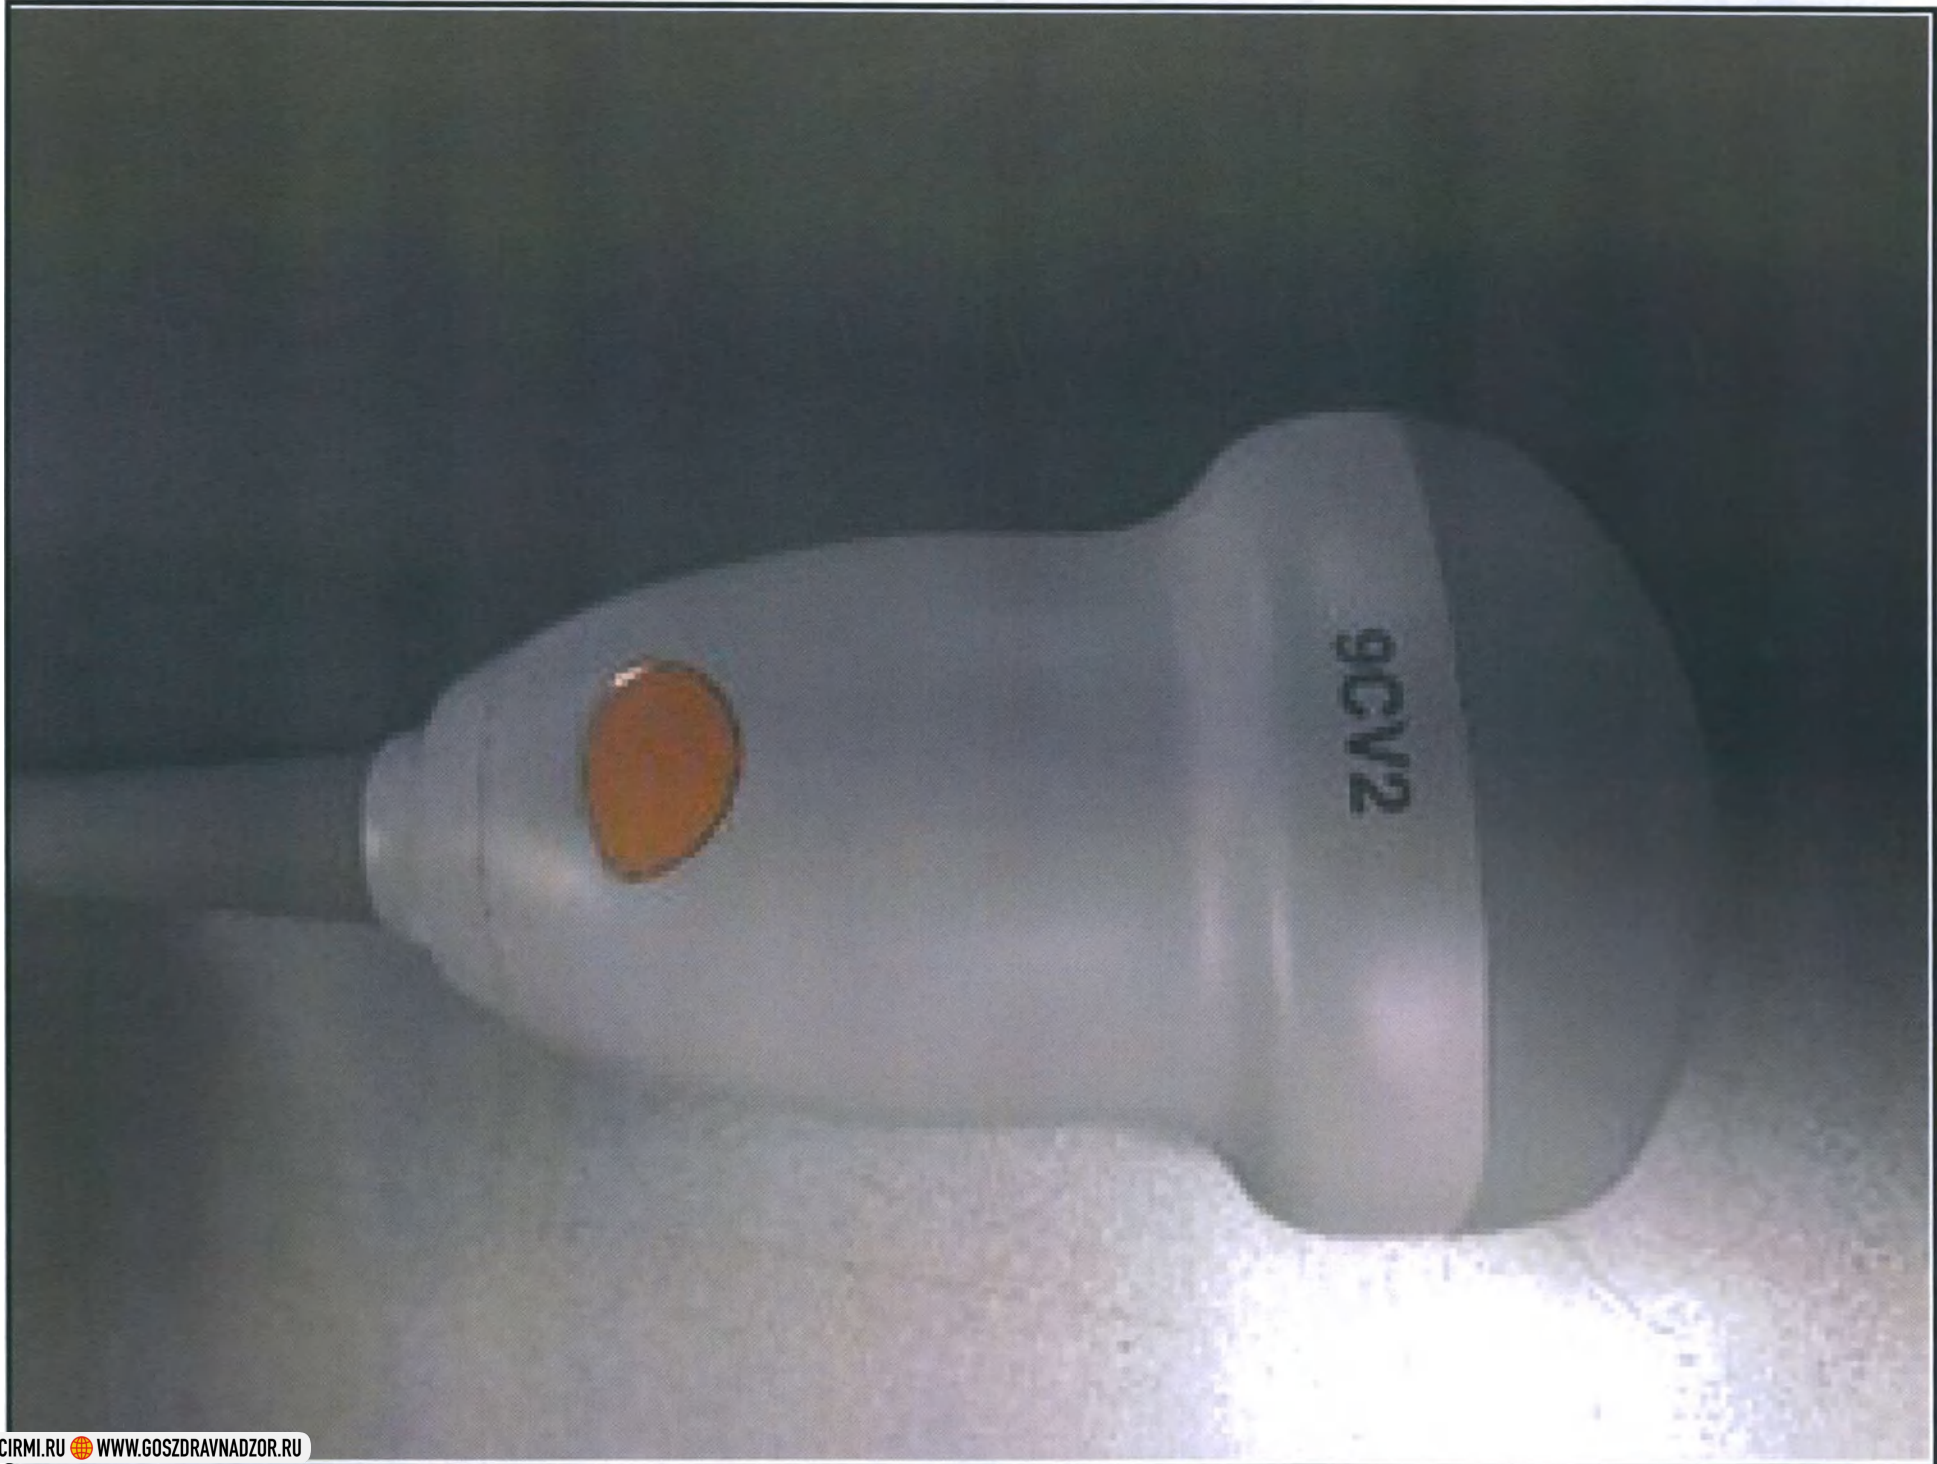








17. Датчик конвексный, модель PVT-745BTF, производства Canon Medical Systems Corporation, Япония, РУ № РЗН 2020/11544 (при необходимости)





17. Датчик конвексный, модель PVT-745BTF, производства Canon Medical Systems Corporation, Япония, РУ № РЗН 2020/11544 (при необходимости)

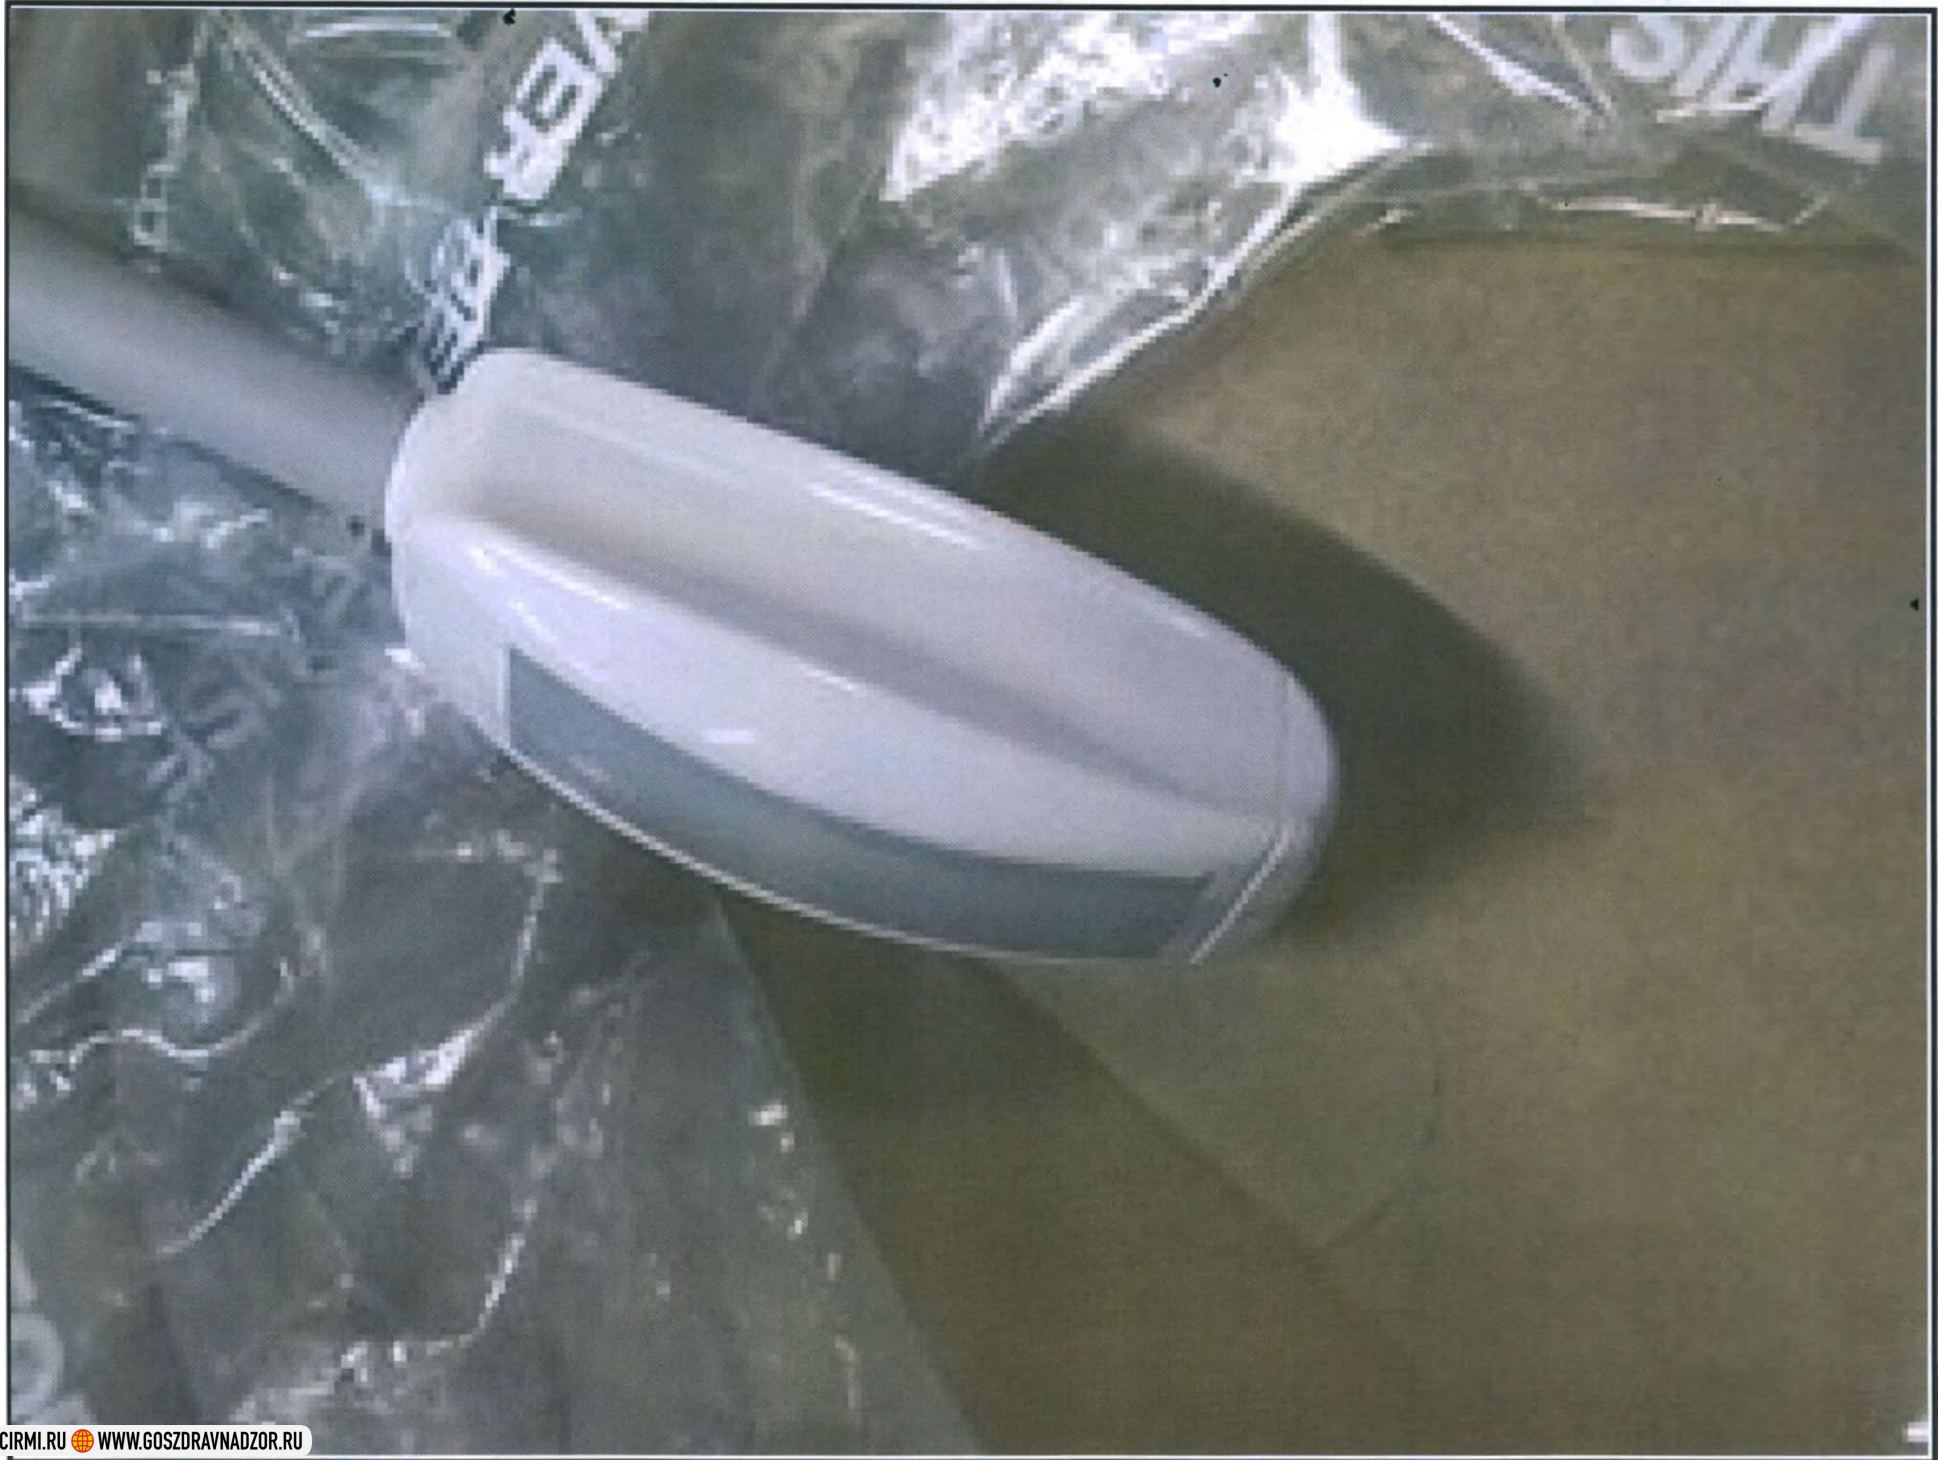



17. Датчик конвексный, модель PVT-745BTF, производства Canon Medical Systems Corporation, Япония, РУ № РЗН 2020/11544 (при необходимости)





18. Датчик конвексный, модель PVT-745BTH, производства Canon Medical Systems Corporation, Япония, РУ № РЗН 2020/11544 (при необходимости)





18. Датчик конвексный, модель PVT-745BTH, производства Canon Medical Systems Corporation, Япония, РУ № РЗН 2020/11544 (при необходимости)









19. Датчик конвексный, модель PVT-745BTV, производства Canon Medical Systems Corporation, Япония, РУ № РЗН 2020/11544 (при необходимости)





19. Датчик конвексный, модель PVT-745BTV, производства Canon Medical Systems Corporation, Япония, РУ № РЗН 2020/11544 (при необходимости)





19. Датчик конвексный, модель PVT-745BTV, производства Canon Medical Systems Corporation, Япония, РУ № РЗН 2020/11544 (при необходимости)






20. Датчик конвексный, модель PVT-712BT, производства Canon Medical Systems Corporation, Япония, РУ № РЗН 2020/11544 (при необходимости)






20. Датчик конвексный, модель PVT-712BT, производства Canon Medical Systems Corporation, Япония, РУ № РЗН 2020/11544 (при необходимости)

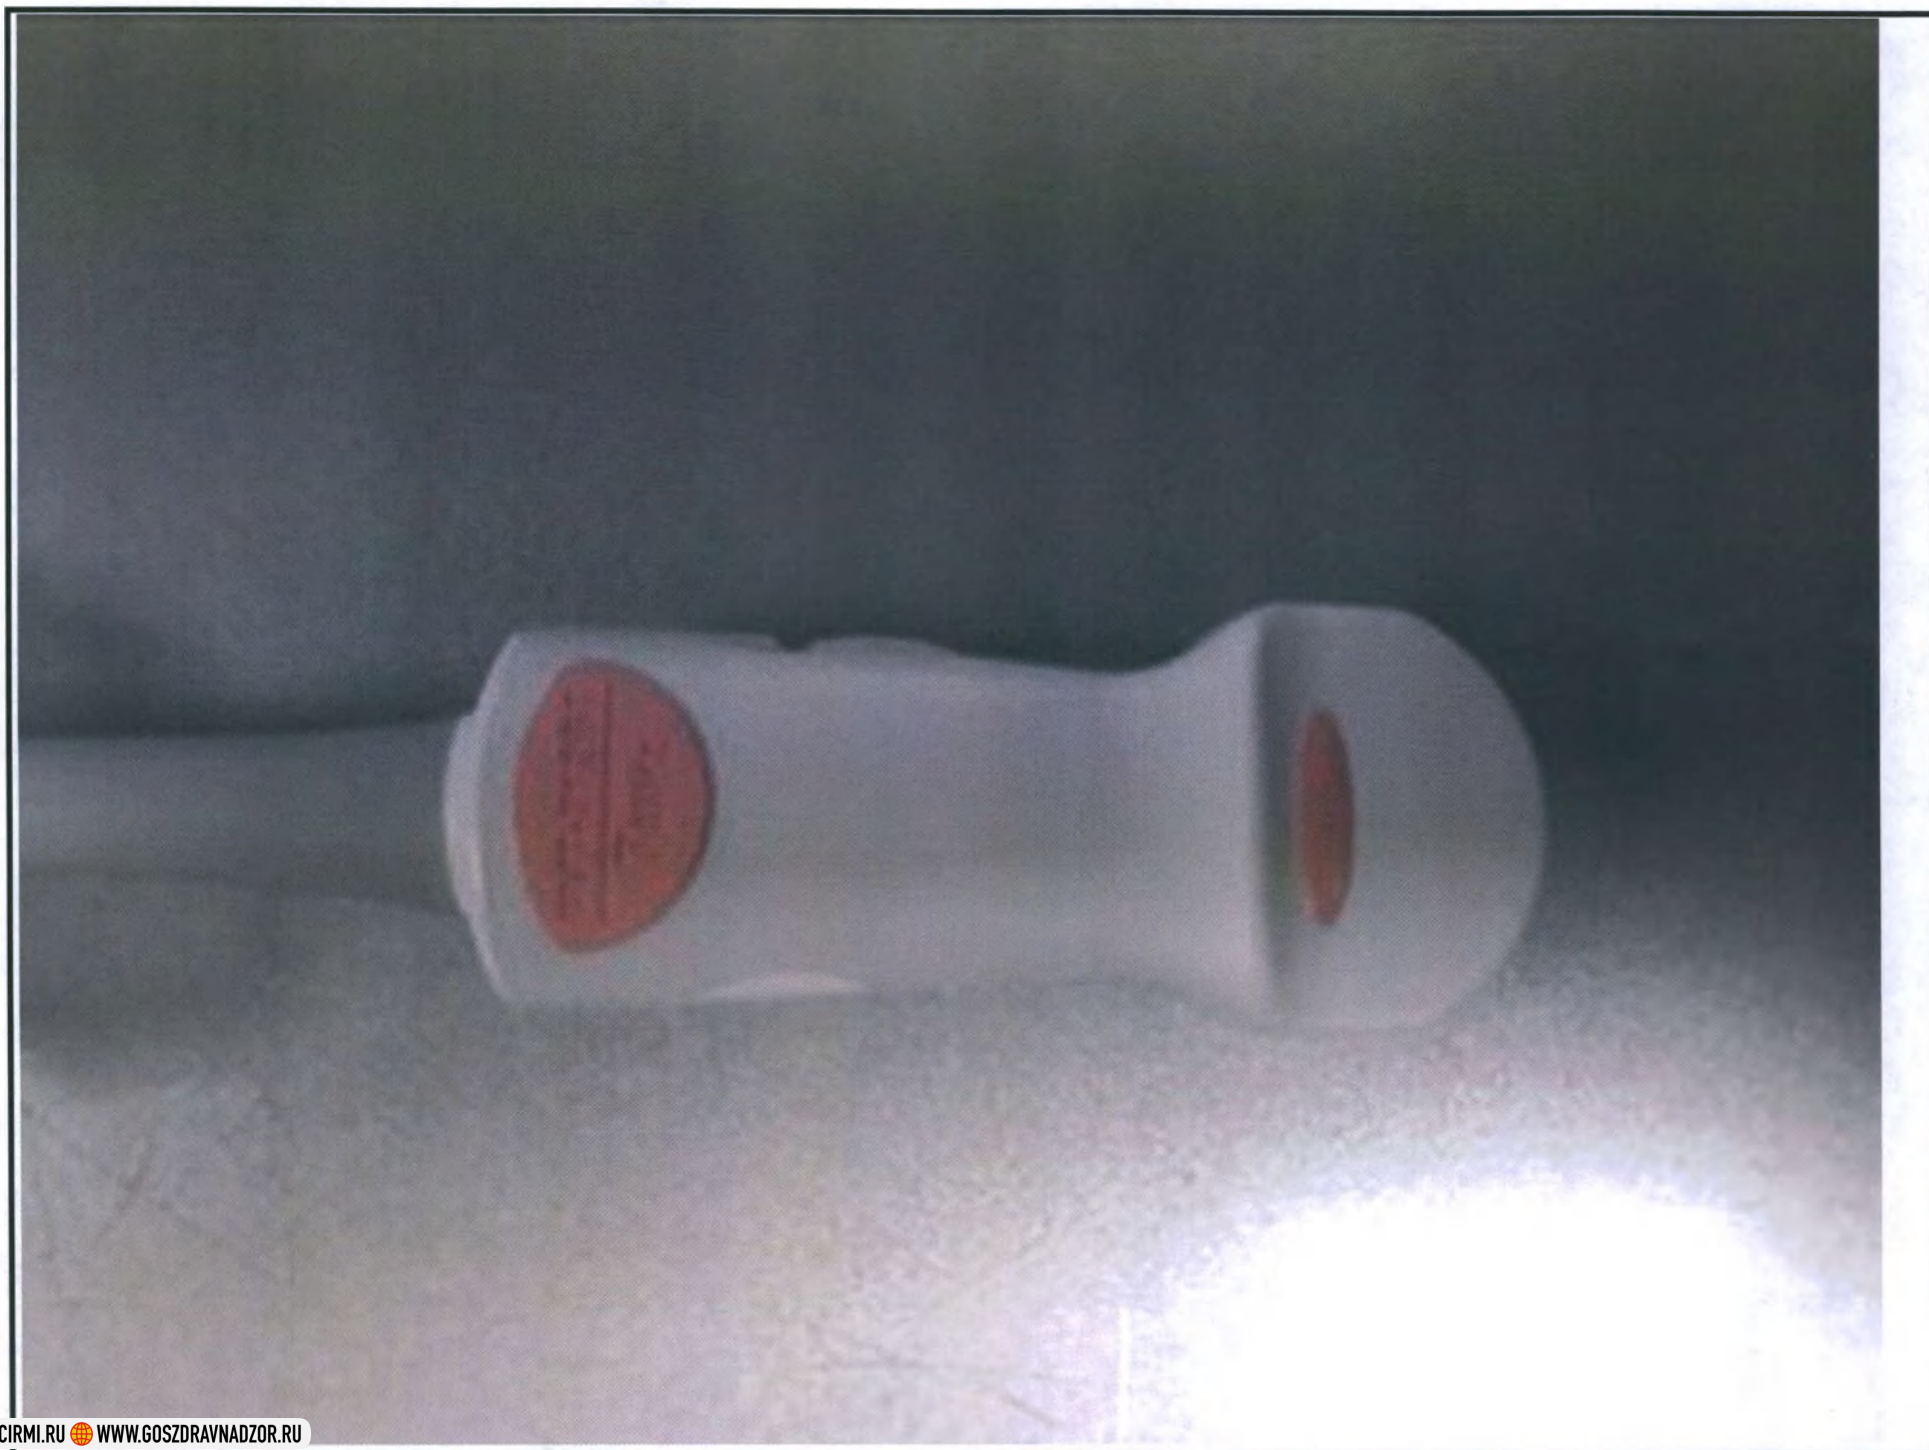



20. Датчик конвексный, модель PVT-712BT, производства Canon Medical Systems Corporation, Япония, РУ № РЗН 2020/11544 (при необходимости)

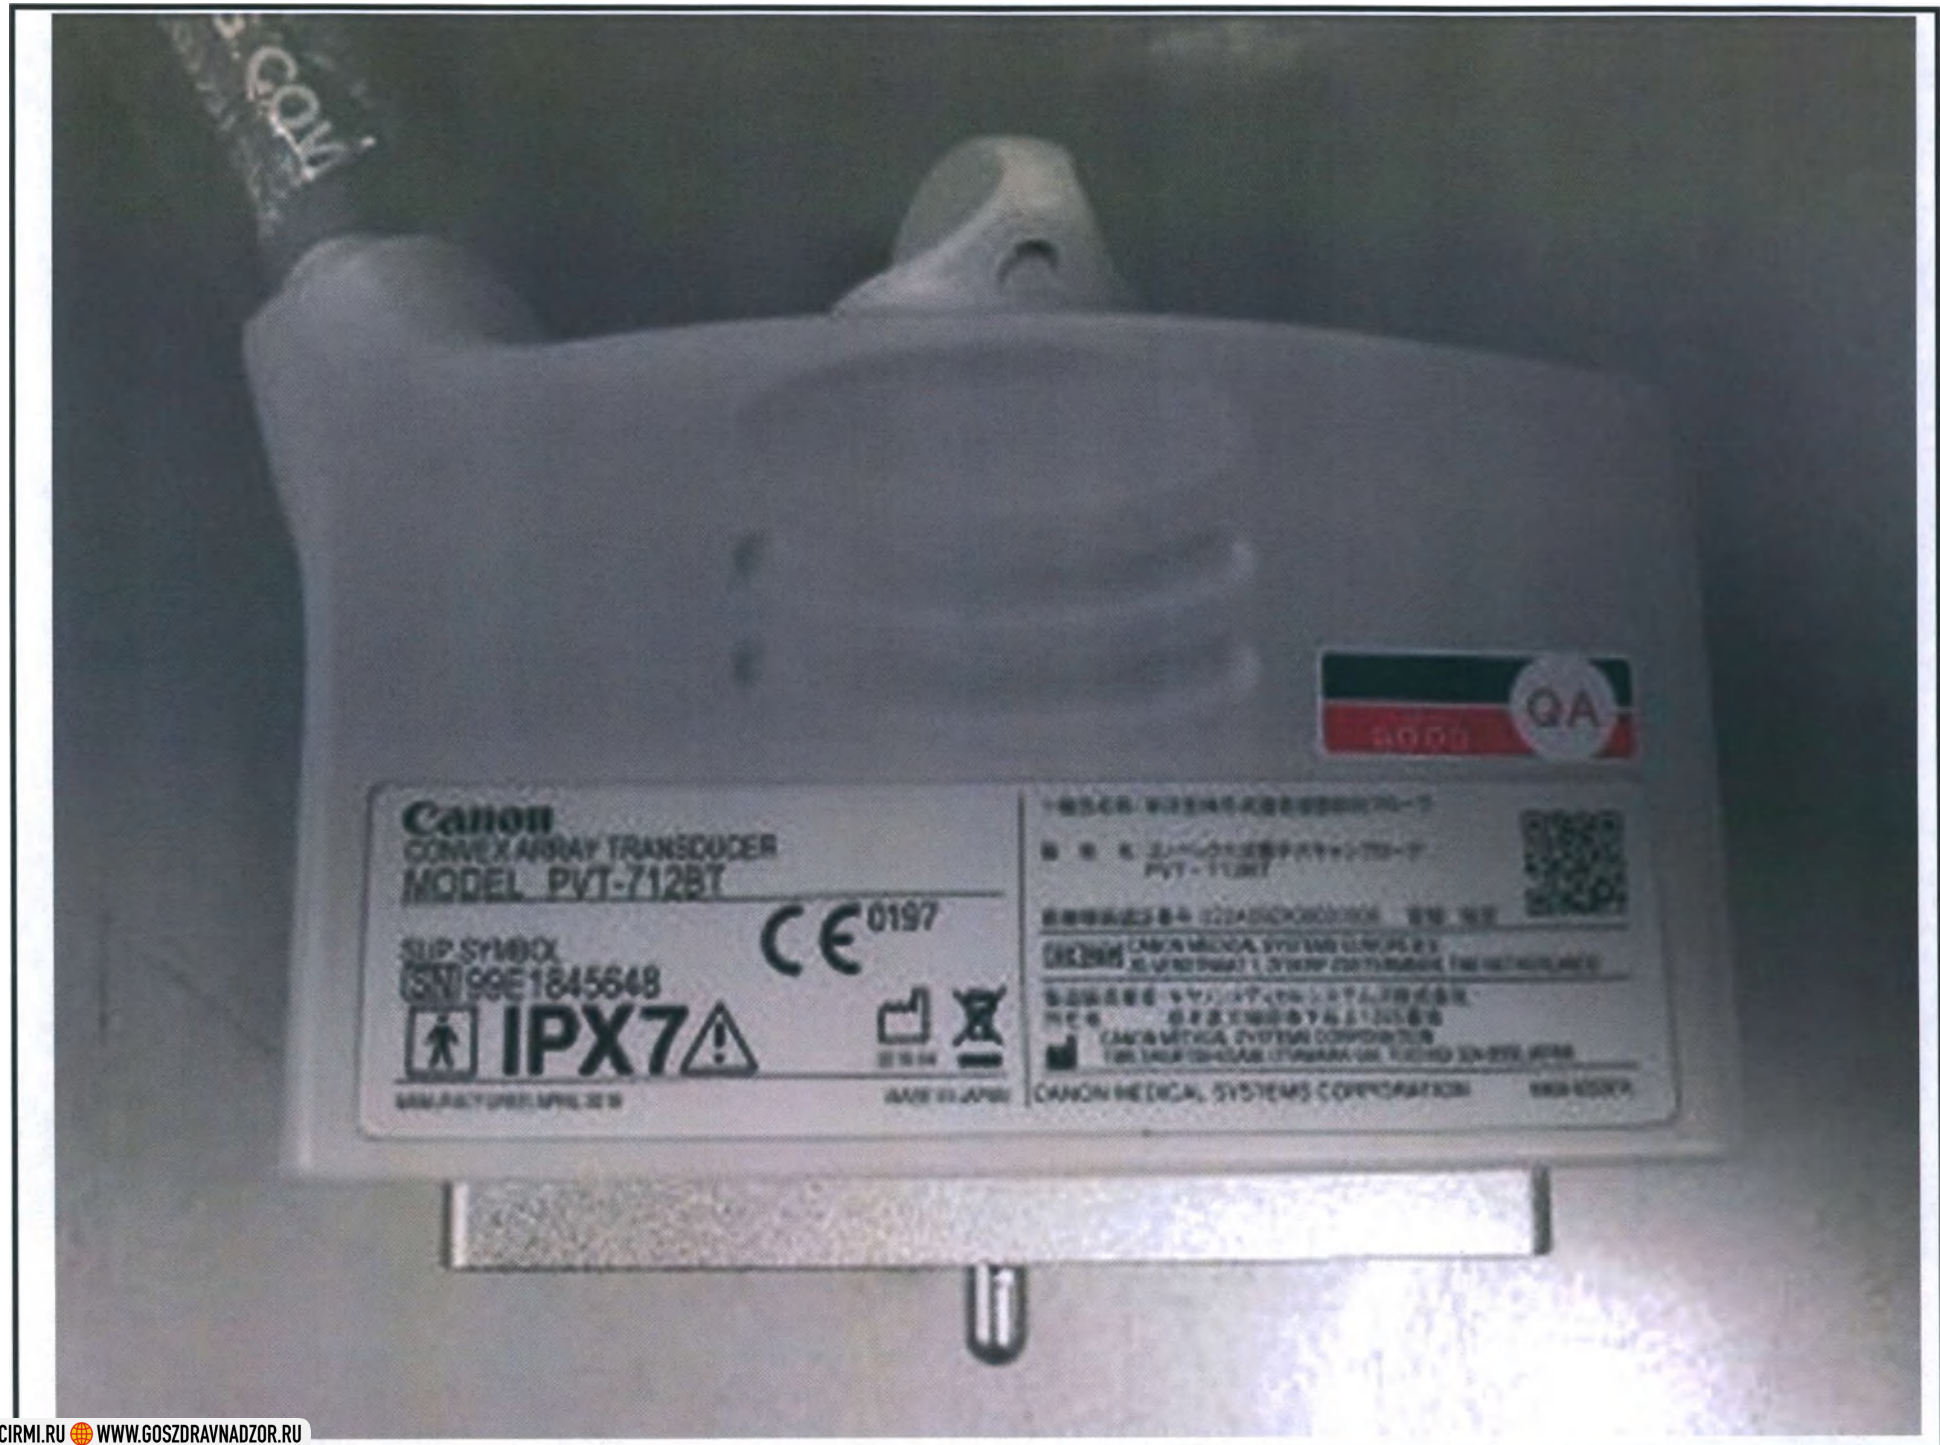



21. Датчик линейный, модель PLT-704SBT, производства Canon Medical Systems Corporation, Япония, РУ № РЗН 2020/11544 (при необходимости)






21. Датчик линейный, модель PLT-704SBT, производства Canon Medical Systems Corporation, Япония, РУ № РЗН 2020/11544 (при необходимости)





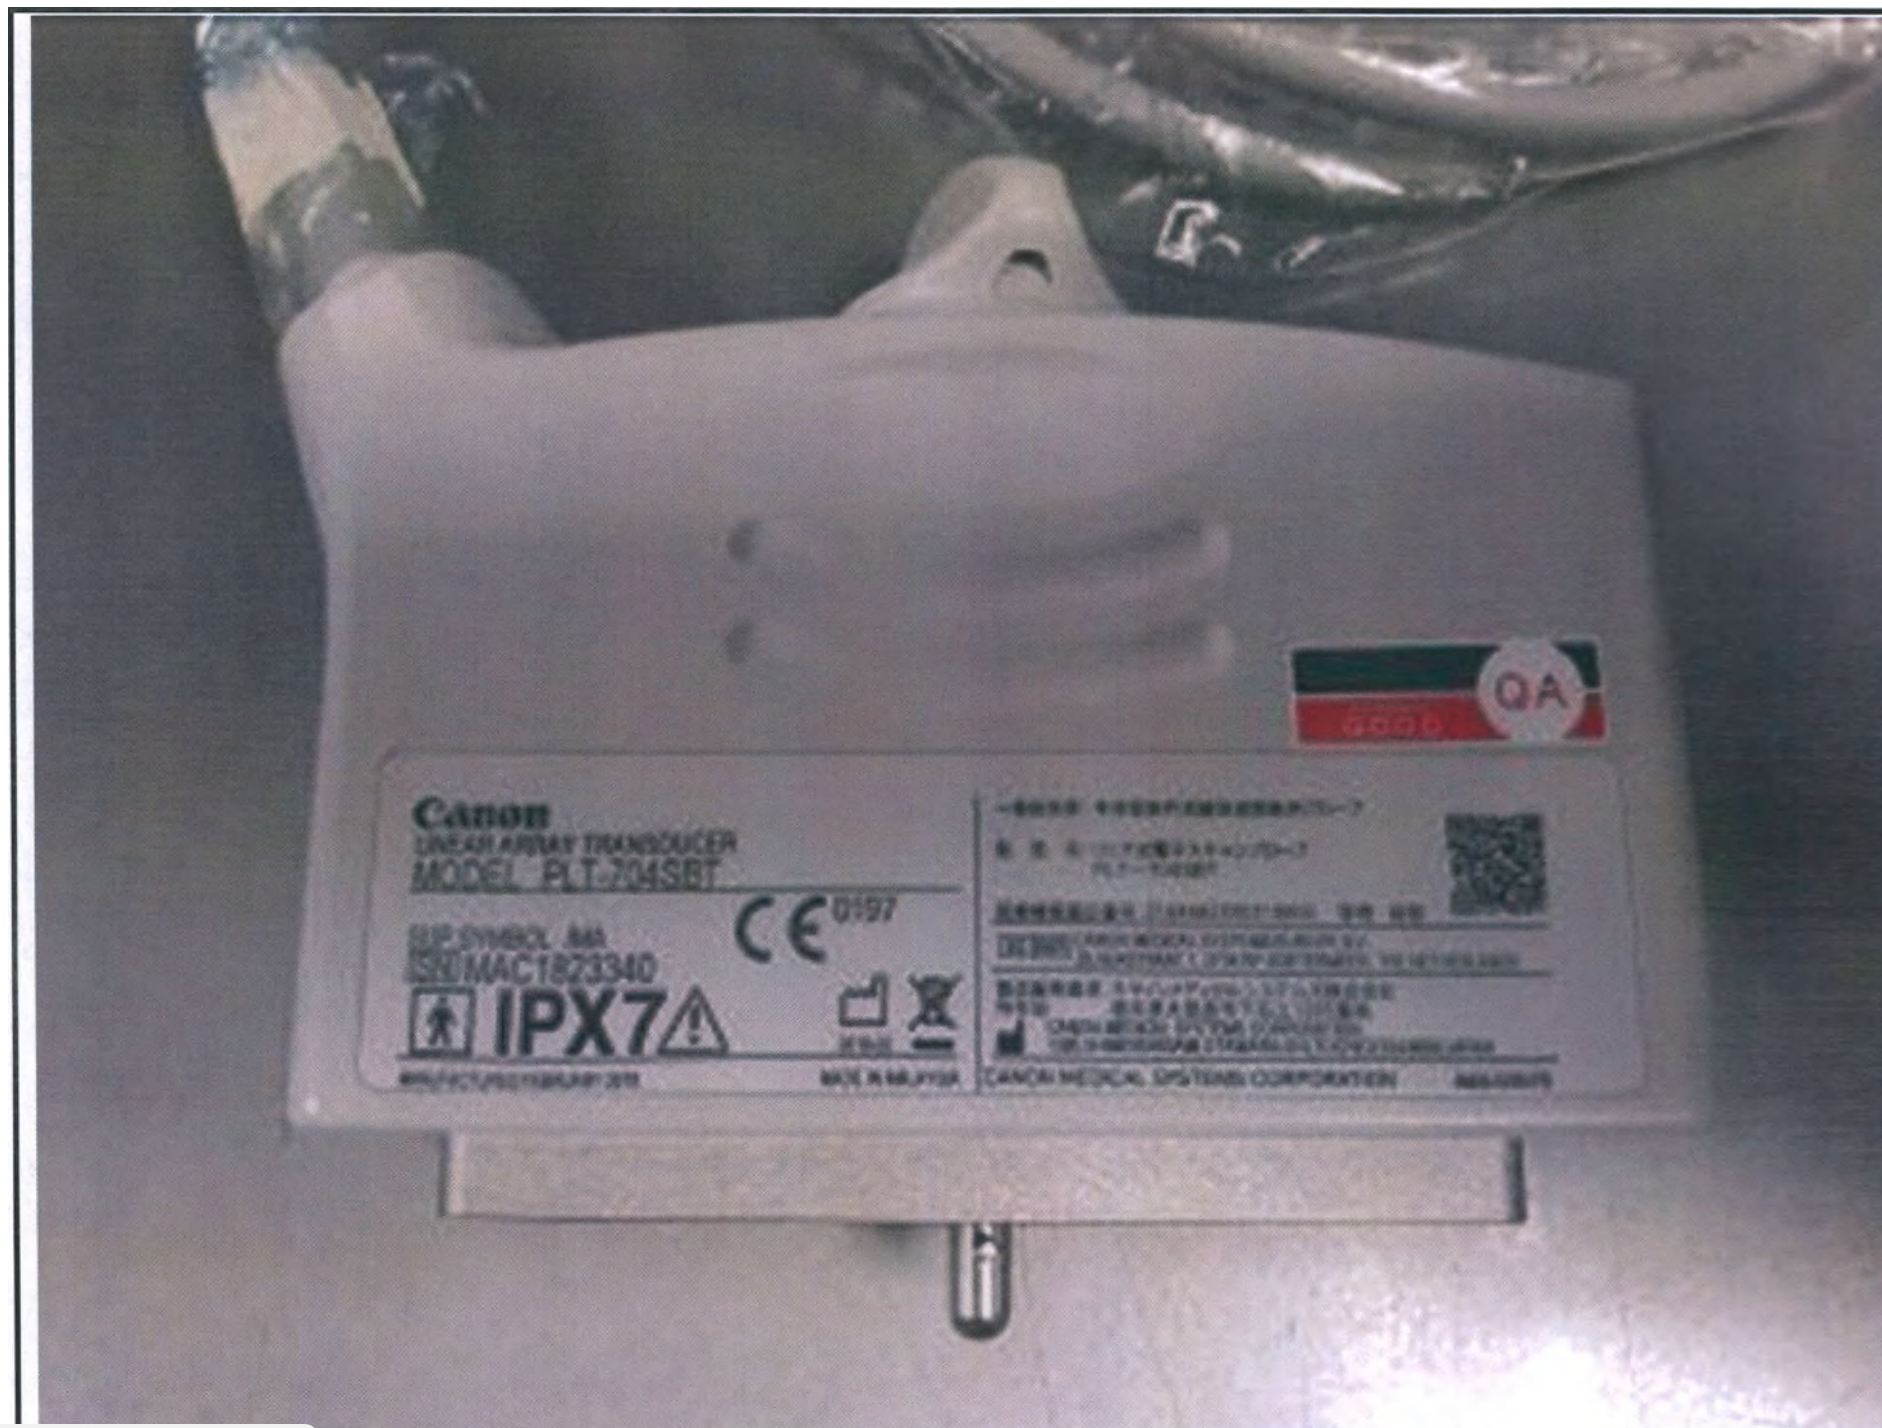



22. Датчик линейный, модель PLT-705BT, производства Canon Medical Systems Corporation, Япония, РУ № РЗН 2020/11544 (при необходимости)






22. Датчик линейный, модель PLT-705BT, производства Canon Medical Systems Corporation, Япония, РУ № РЗН 2020/11544 (при необходимости)





22. Датчик линейный, модель PLT-705BT, производства Canon Medical Systems Corporation, Япония, РУ № РЗН 2020/11544 (при необходимости)

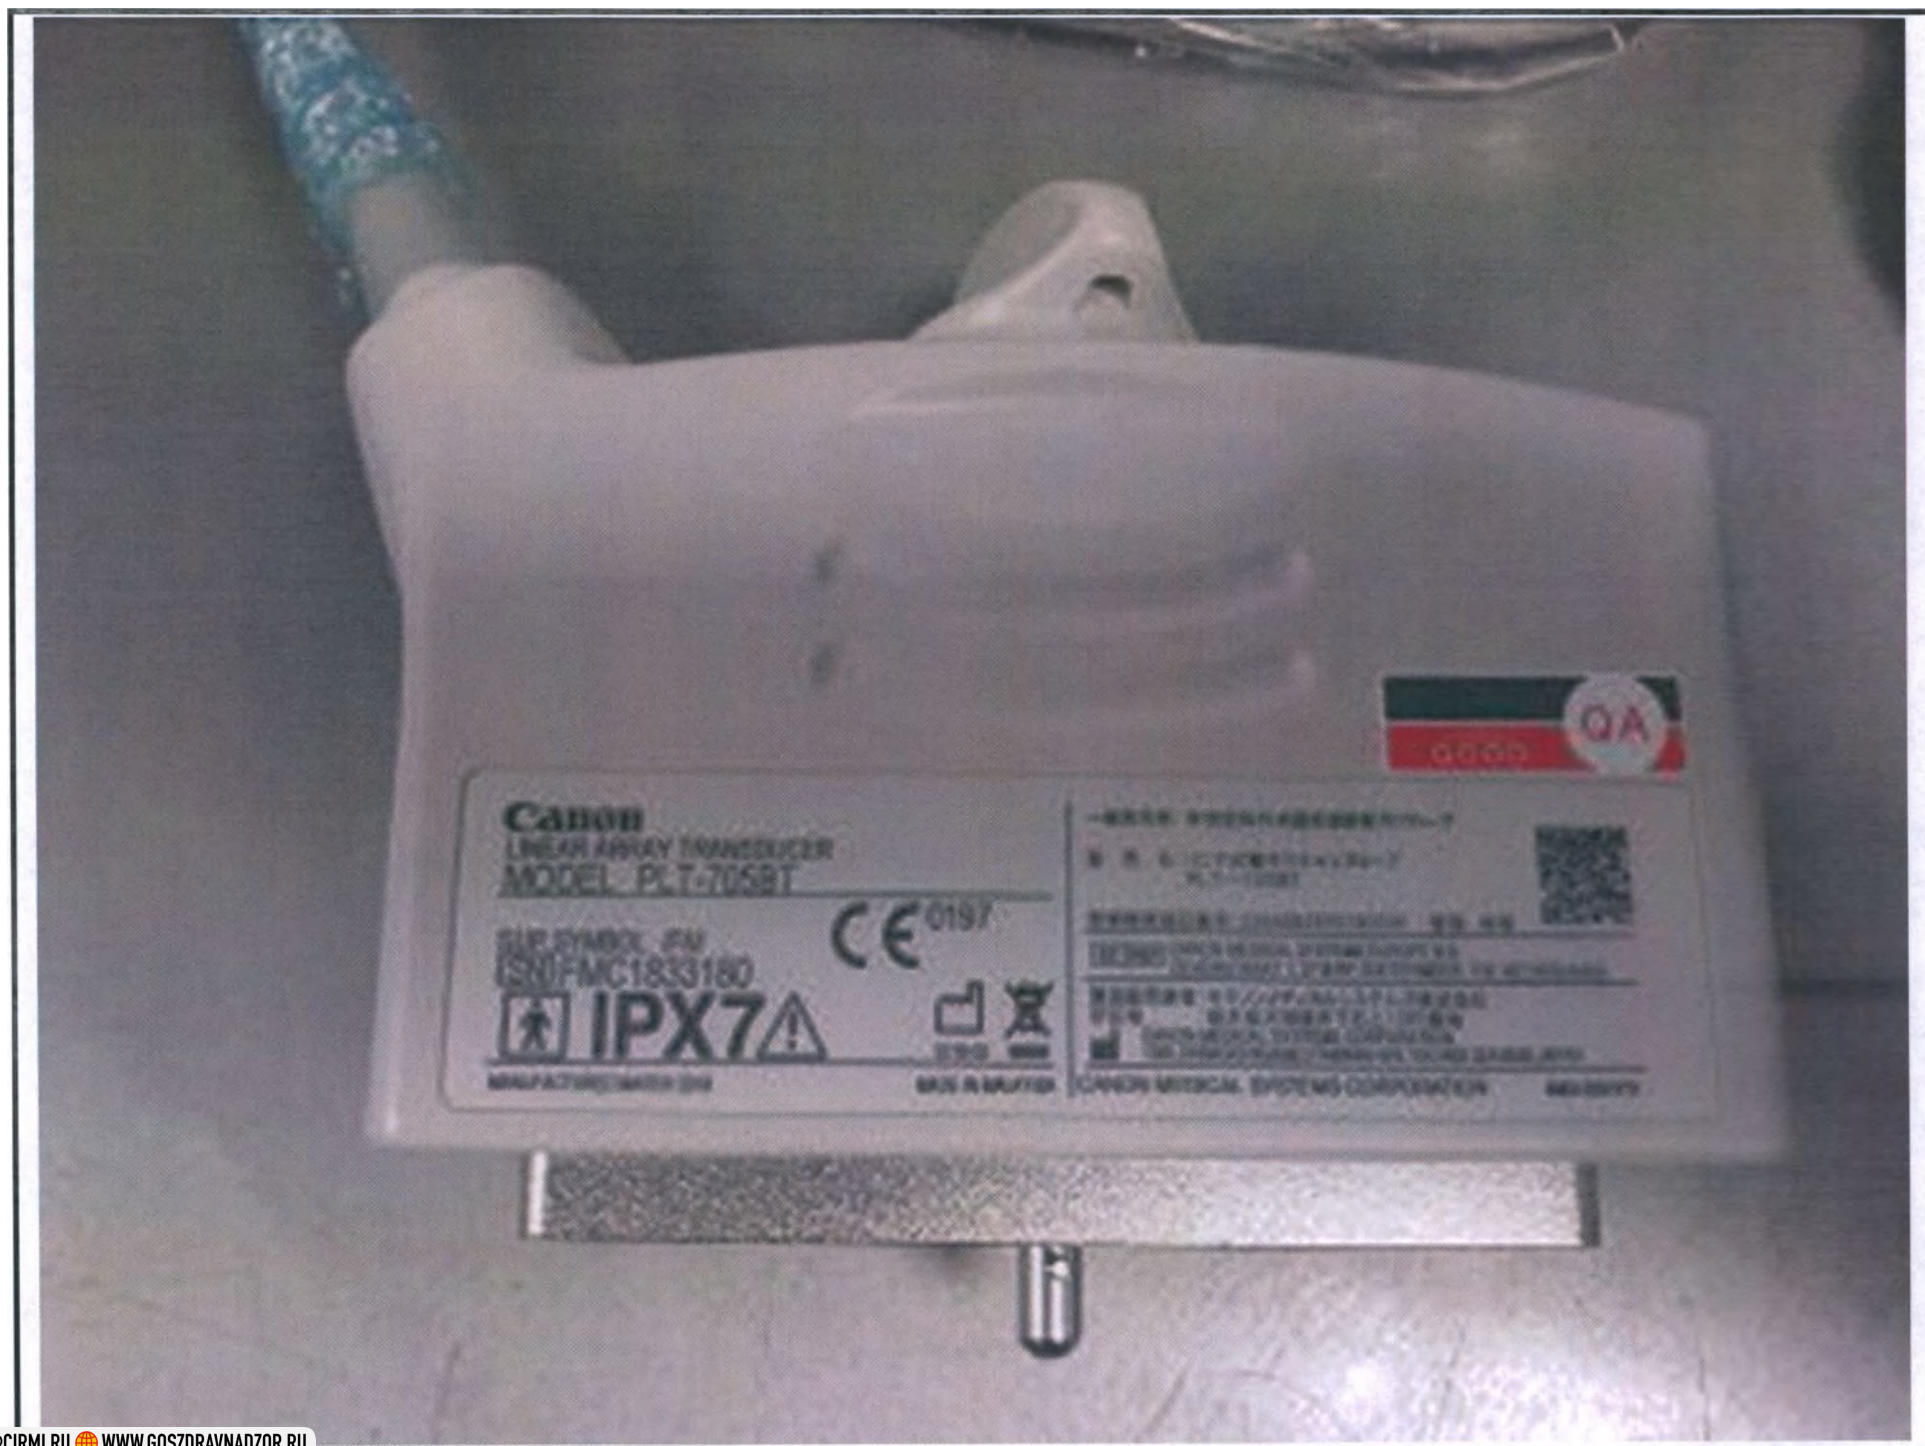








23. Датчик линейный, модель PLT-705BTF, производства Canon Medical Systems Corporation, Япония, РУ № РЗН 2020/11544 (при необходимости)





23. Датчик линейный, модель PLT-705BTF, производства Canon Medical Systems Corporation, Япония, РУ № РЗН 2020/11544 (при необходимости)

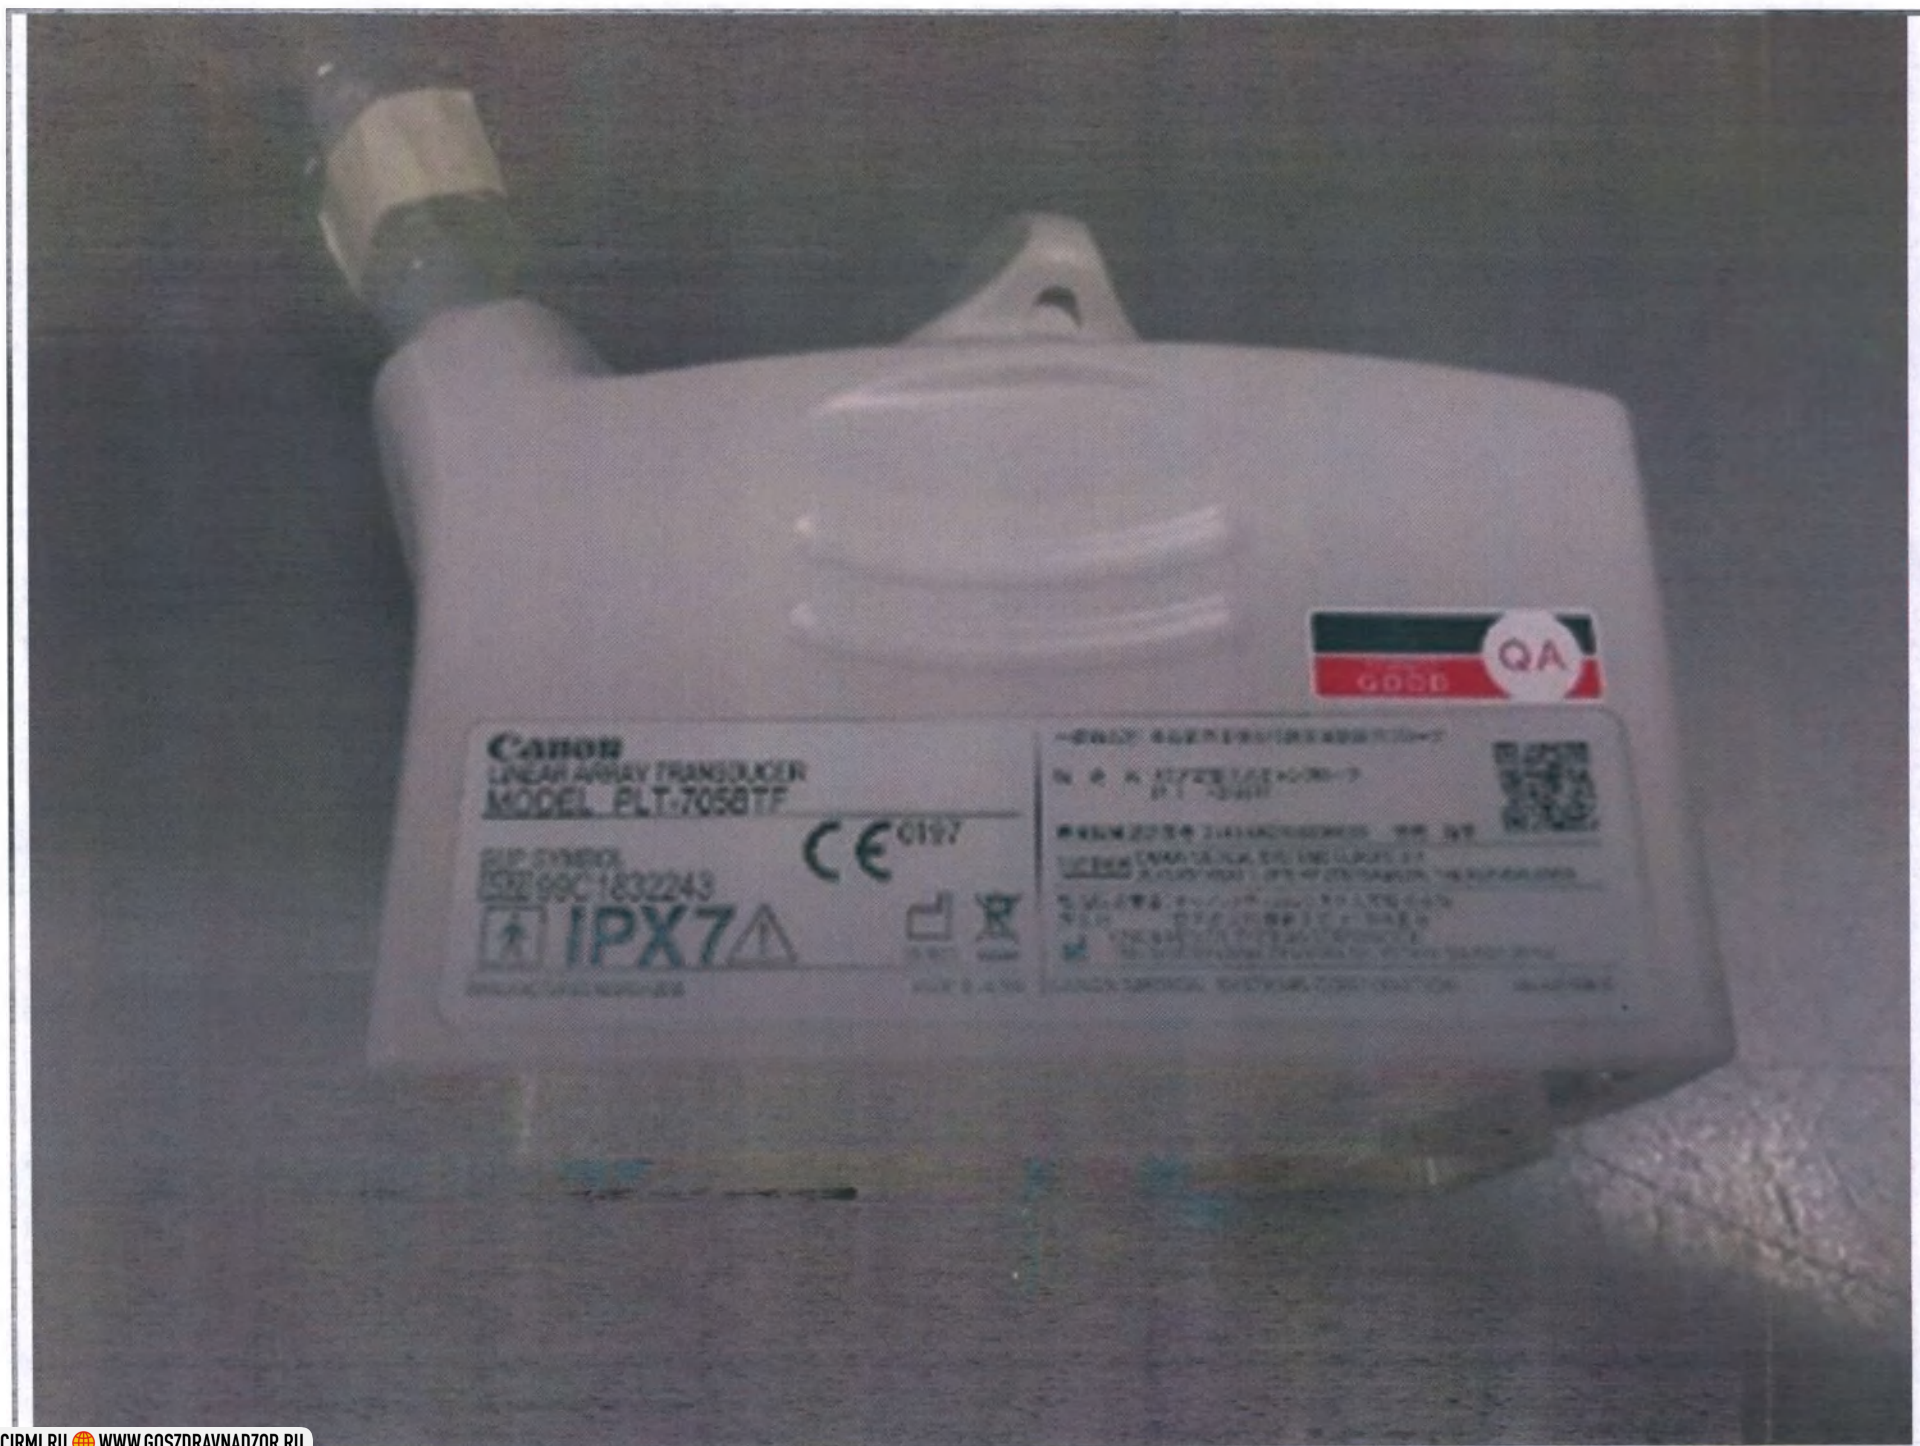



24. Датчик линейный, модель PLT-705ВТН, производства Canon Medical Systems Corporation, Япония, РУ № РЗН 2020/11544 (при необходимости)





24. Датчик линейный, модель PLT-705BTH, производства Canon Medical Systems Corporation, Япония, РУ № РЗН 2020/11544 (при необходимости)





25. Датчик линейный, модель PLT-1005BT, производства Canon Medical Systems Corporation, Япония, РУ № РЗН 2020/11544 (при необходимости)





25. Датчик линейный, модель PLT-1005BT, производства Canon Medical Systems Corporation, Япония, РУ № РЗН 2020/11544 (при необходимости)






25. Датчик линейный, модель PLT-1005BT, производства Canon Medical Systems Corporation, Япония, РУ № РЗН 2020/11544 (при необходимости)





26. Датчик линейный, модель PLT-1204BT, производства Canon Medical Systems Corporation, Япония, РУ № РЗН 2020/11544 (при необходимости)

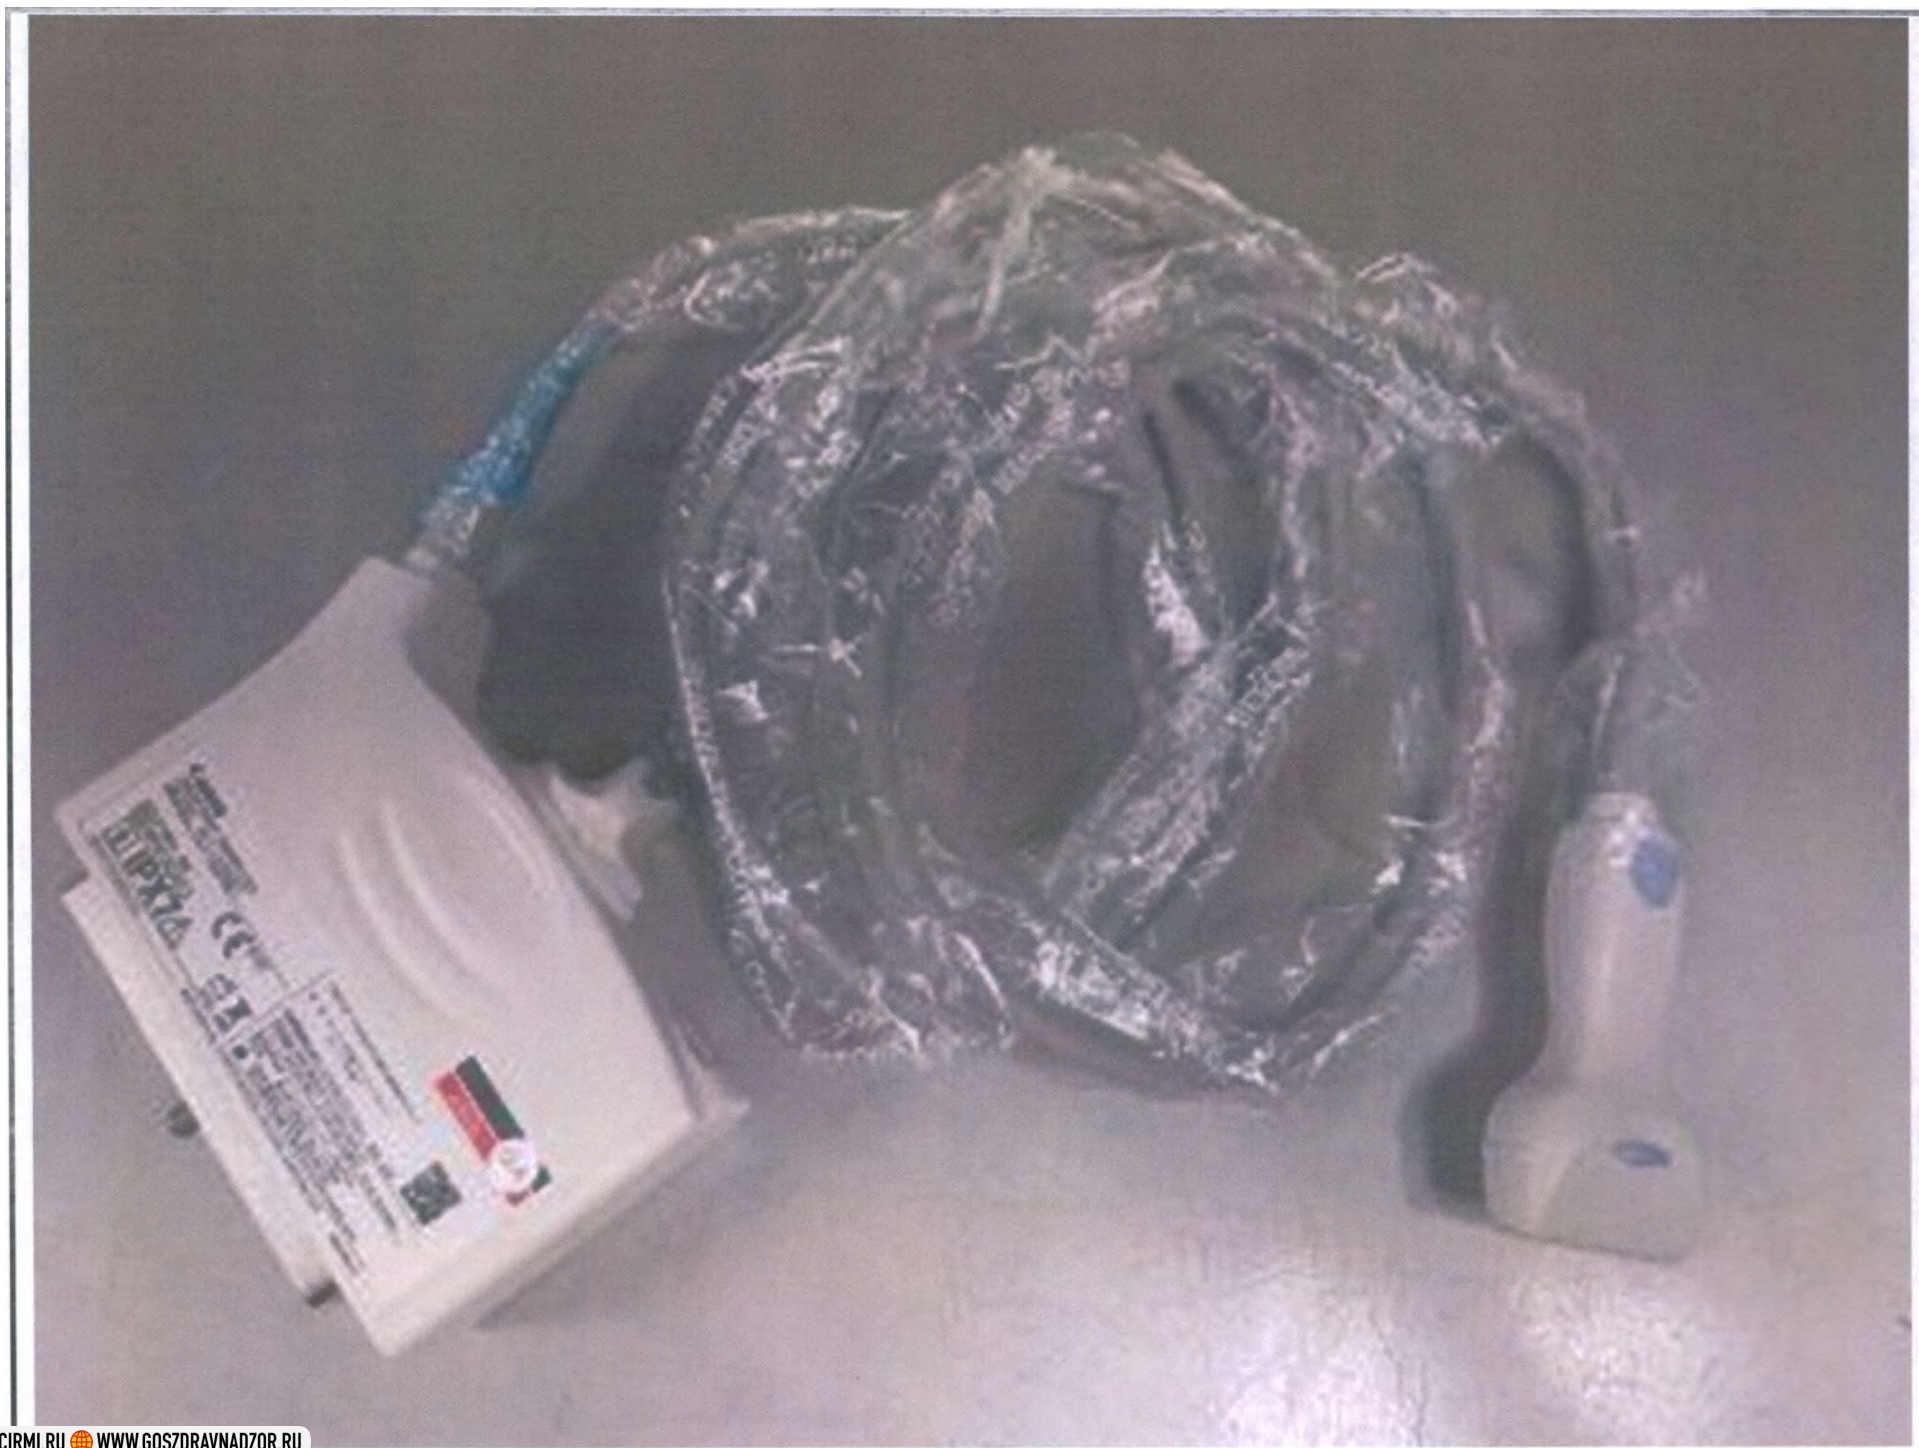



26. Датчик линзыйный, модель PLT-1204BT, производства Canon Medical Systems Corporation, Япония, РУ № РЗН 2020/11544 (при необходимости)






26. Датчик линейный, модель PLT-1204BT, производства Canon Medical Systems Corporation, Япония, РУ № РЗН 2020/11544 (при необходимости)





27. Датчик линейный, модель PLT-1202BT, производства Canon Medical Systems Corporation, Япония, РУ № РЗН 2020/11544 (при необходимости)

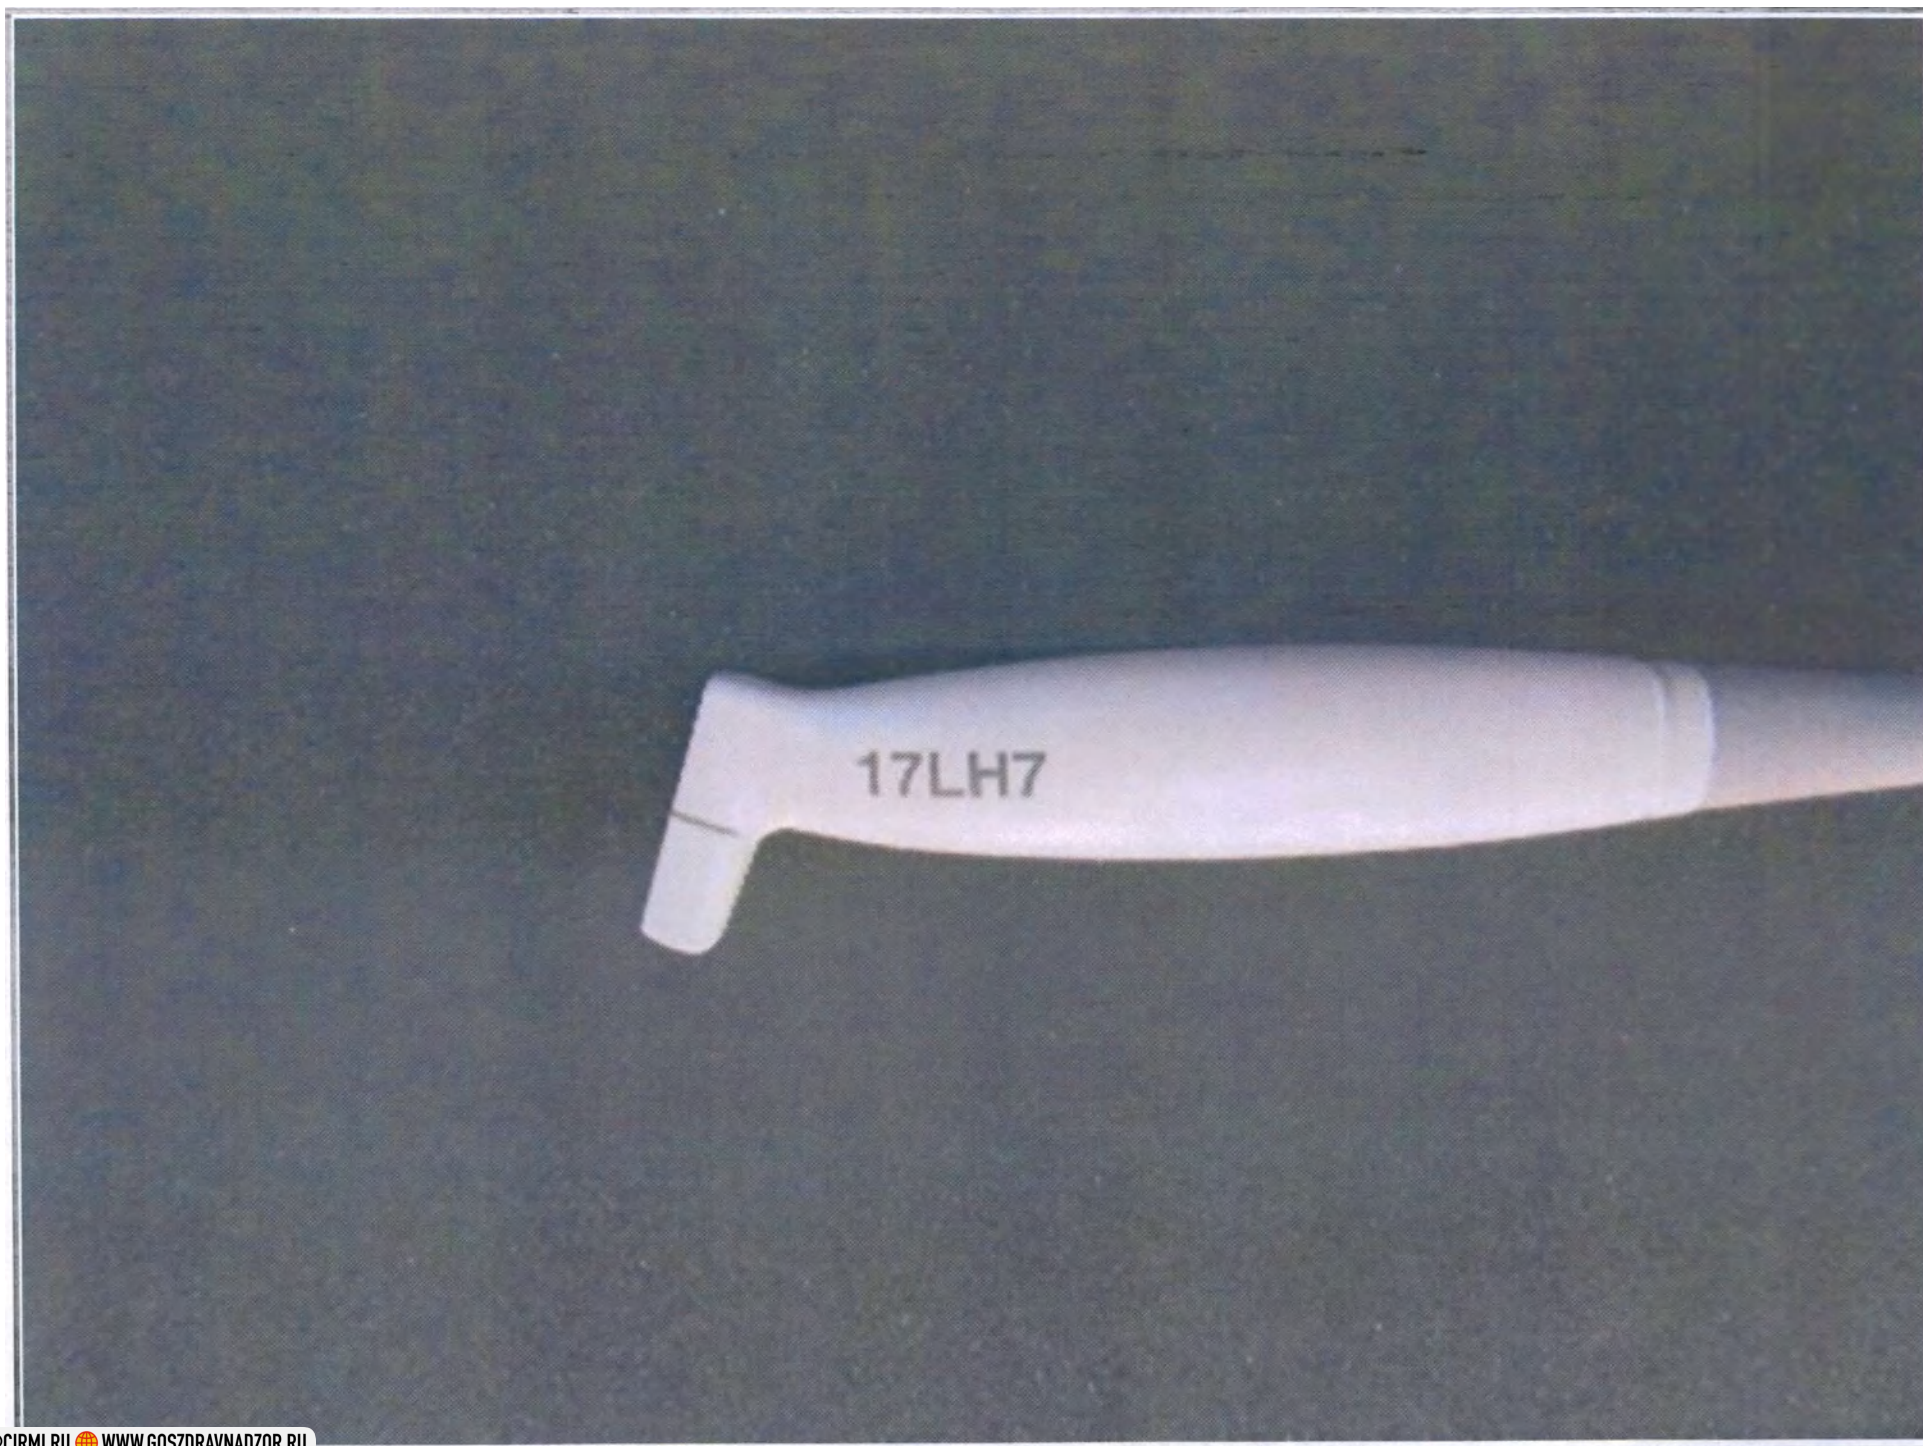




27. Датчик линейный, модель PLT-1202BT, производства Canon Medical Systems Corporation, Япония, РУ № РЗН 2020/11544 (при необходимости)





27. Датчик линейный, модель PLT-1202BT, производства Canon Medical Systems Corporation, Япония, РУ № P3II 2020/11544 (при необходимости)

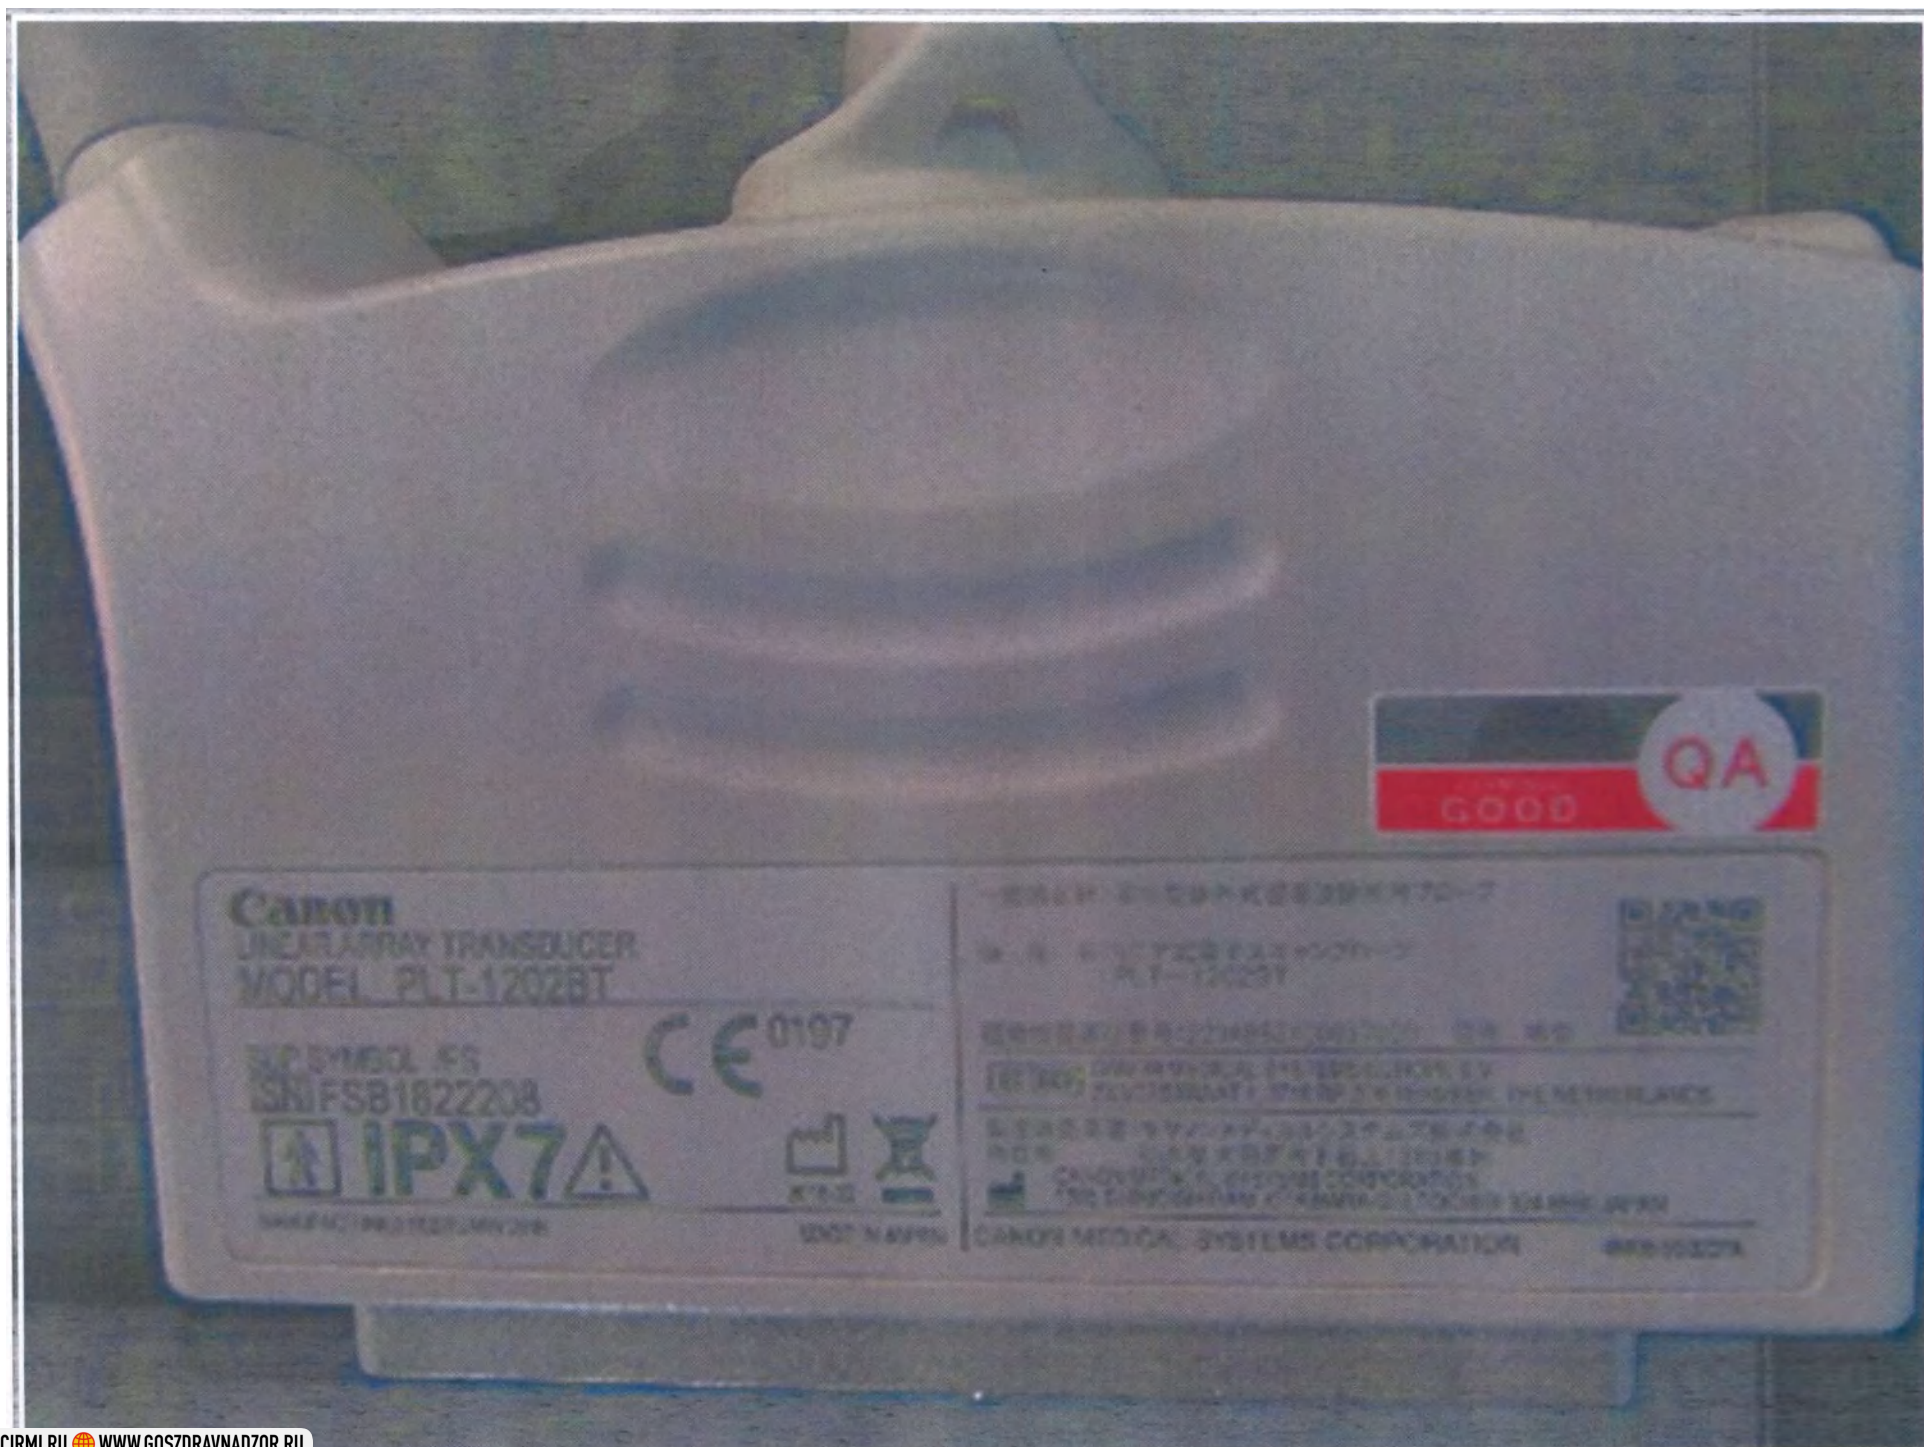




28. Датчик линейный биопсийный, модель PL-T-308BTP, производства Canon Medical Systems Corporation, Япония, РУ № РЗН 2020/11544 (при необходимости)





28. Датчик линейный биопсийный, модель PLT-308BTP, производства Canon Medical Systems Corporation, Япония, РУ № РЗН 2020/11544 (при необходимости)

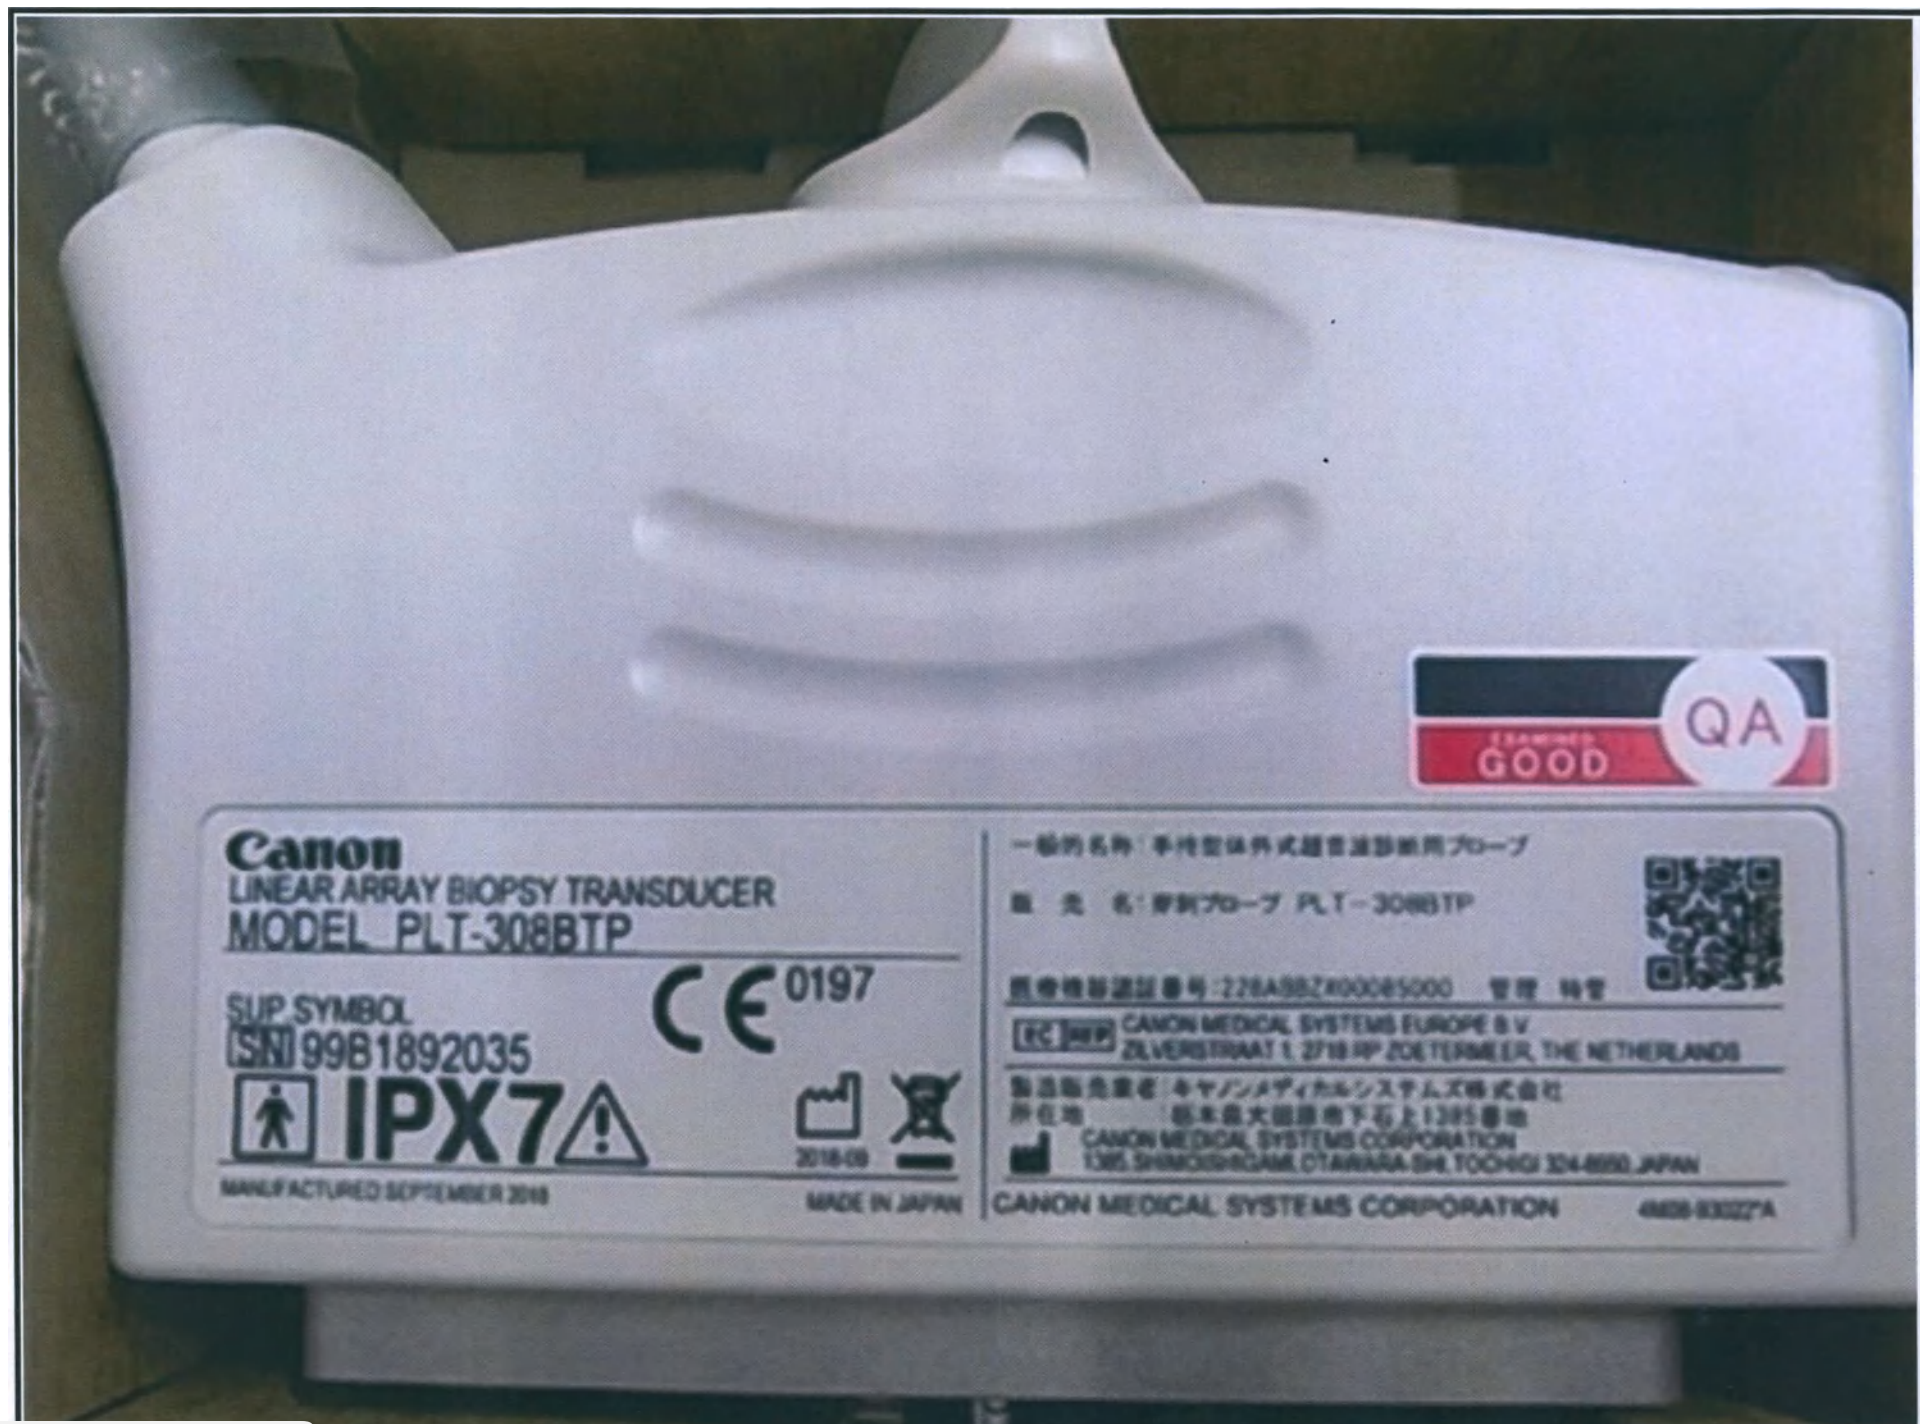



28. Датчик линейный биопсийный, модель PLT-308BTP, производства Canon Medical Systems Corporation, Япония, РУ № РЗН 2020/11544 (при необходимости)






29. Датчик линейный, модель PET-805LA, производства Canon Medical Systems Corporation, Япония, РУ № РЗН 2020/11544 (при необходимости)





29. Датчик линейный, модель PET-805LA, производства Canon Medical Systems Corporation, Япония, РУ № РЗН 2020/11544 (при необходимости)

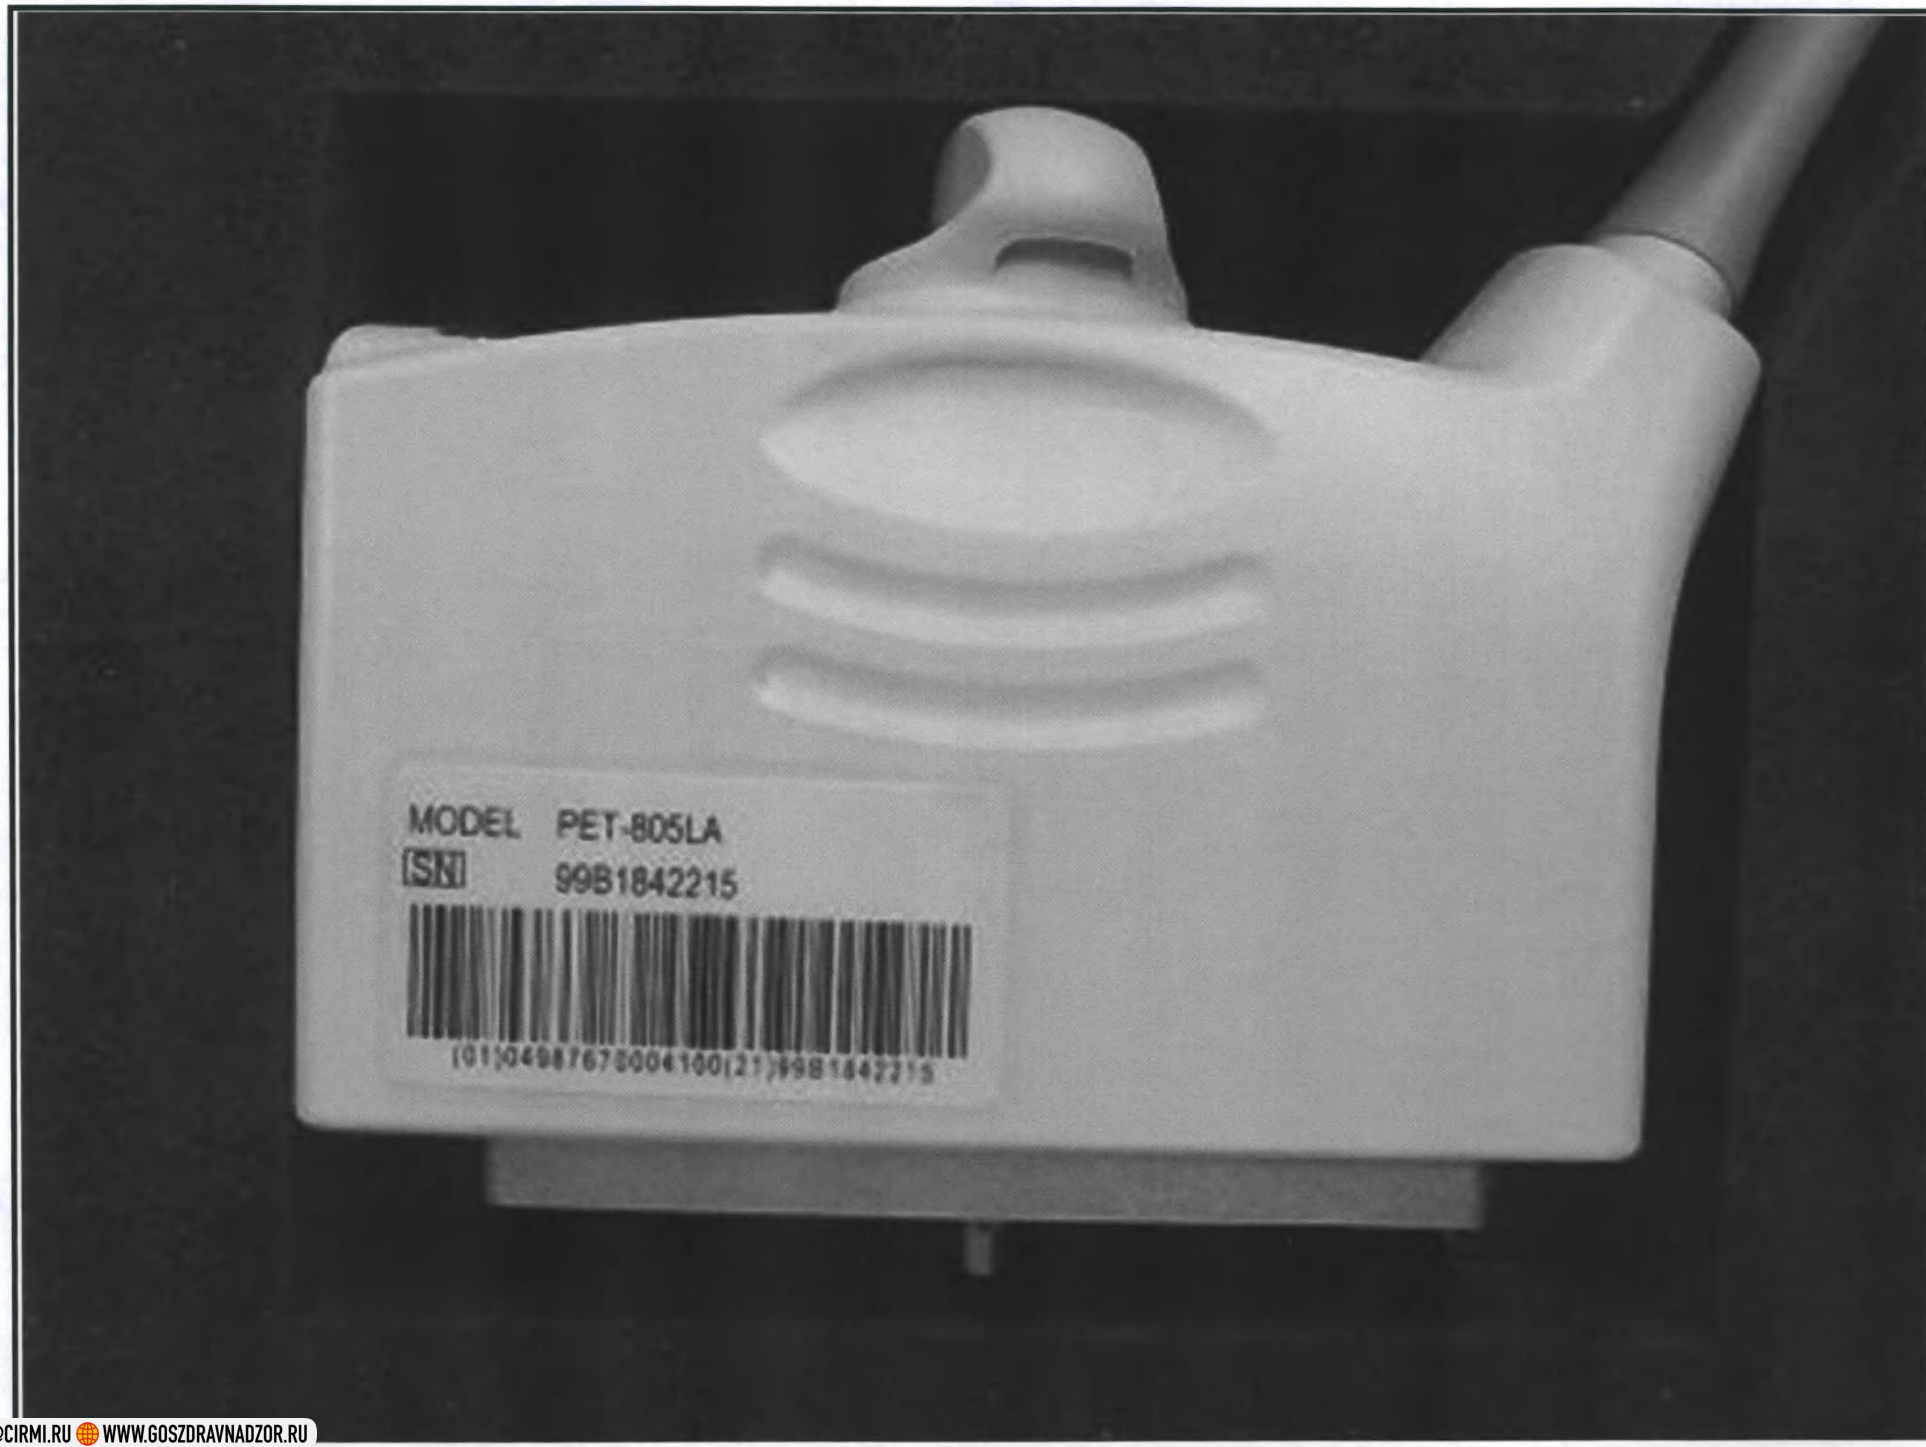



29. Датчик линейный, модель PET-805LA, производства Canon Medical Systems Corporation, Япония, РУ № РЗН 2020/11544 (при необходимости)





30. Датчик транспищеводный мультиплановый, модель PET-512MD, производства Canon Medical Systems Corporation, Япония, РУ № РЗН 2020/11544 (при необходимости)





30. Датчик транспищеводный мультиплановый, модель PET-512MD, производства Canon Medical Systems Corporation, Япония, РУ № РЗН 2020/11544 (при необходимости)











31. Датчик внутрисполостной, модель PVT-681MVL, производства Canon Medical Systems Corporation, Япония, РУ № РЗН 2020/11544 (при необходимости)

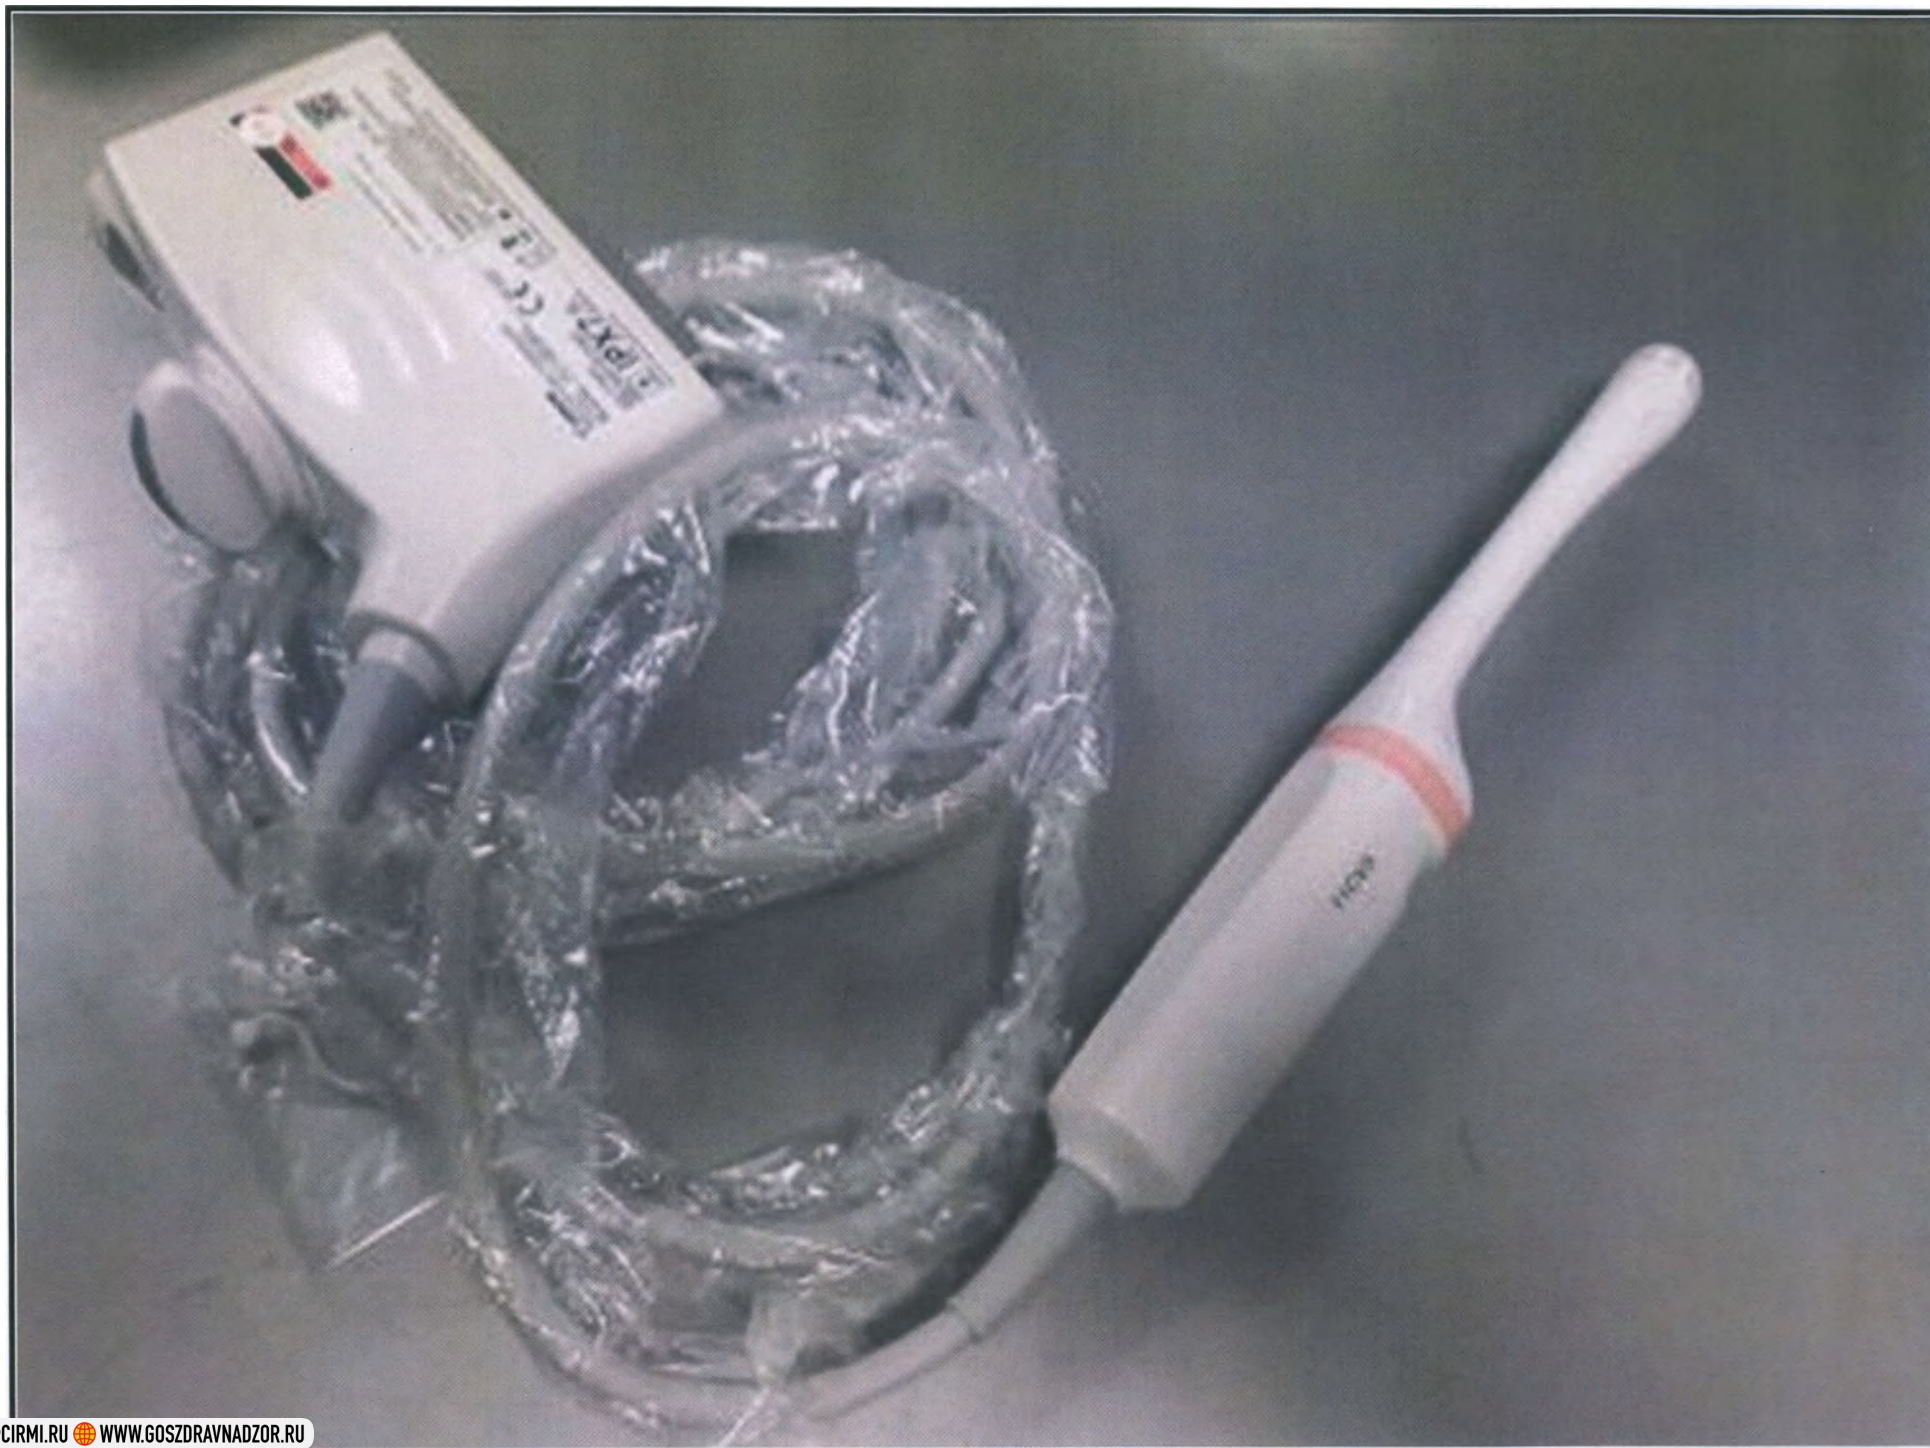



31. Датчик внутриматочный, модель PVT-681MVL, производства Canon Medical Systems Corporation, Япония, РУ № РЗН 2020/11544 (при необходимости)

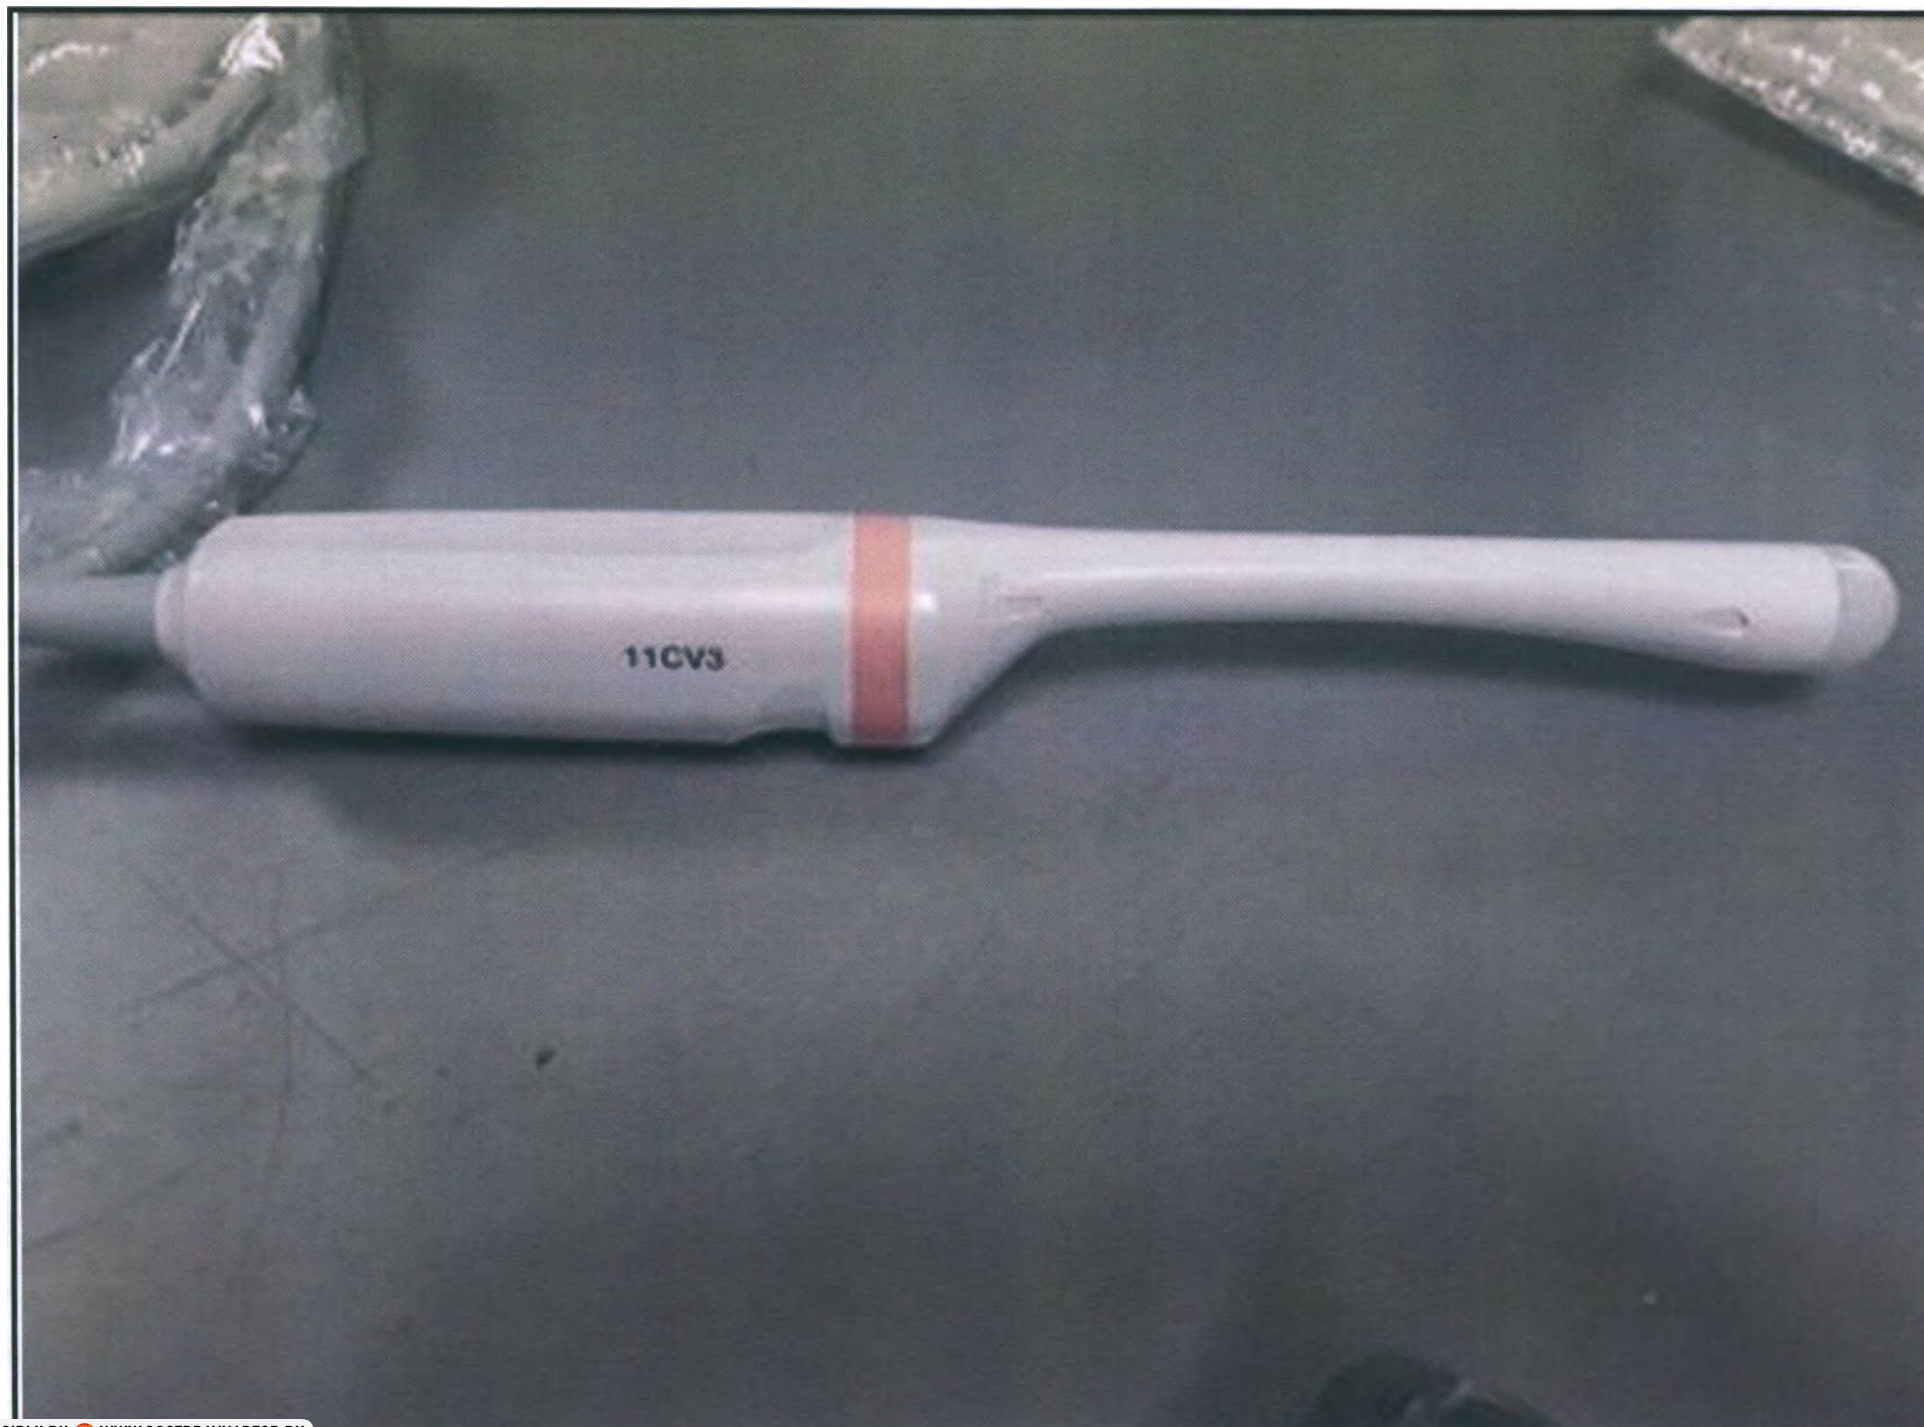



31. Датчик внутриматочной, модель PVT-681MVL, производства Canon Medical Systems Corporation, Япония, РУ № РЗН 2020/11544 (при необходимости)





32. Датчик внутривидеолостной, модель PVL-715RST, производства Canon Medical Systems Corporation, Япония, РУ № РЗН 2020/11544 (при необходимости)





32. Датчик внутриматочный, модель PVL-715RST, производства Canon Medical Systems Corporation, Япония, РУ № РЗН 2020/11544 (при необходимости)





32. Датчик внутриматочной, модель PVL-715RST, производства Canon Medical Systems Corporation, Япония, РУ № РЗН 2020/11544 (при необходимости)





33. Датчик внутриполостной, модель PVT-781VT, производства Canon Medical Systems Corporation, Япония, РУ № РЗН 2020/11544 (при необходимости)






33. Датчик внутриматочный, модель PVT-781VT, производства Canon Medical Systems Corporation, Япония, РУ № РЗН 2020/11544 (при необходимости)





33. Датчик внутриполостной, модель PVT-781VT, производства Canon Medical Systems Corporation, Япония, РУ № РЗН 2020/11544 (при необходимости)

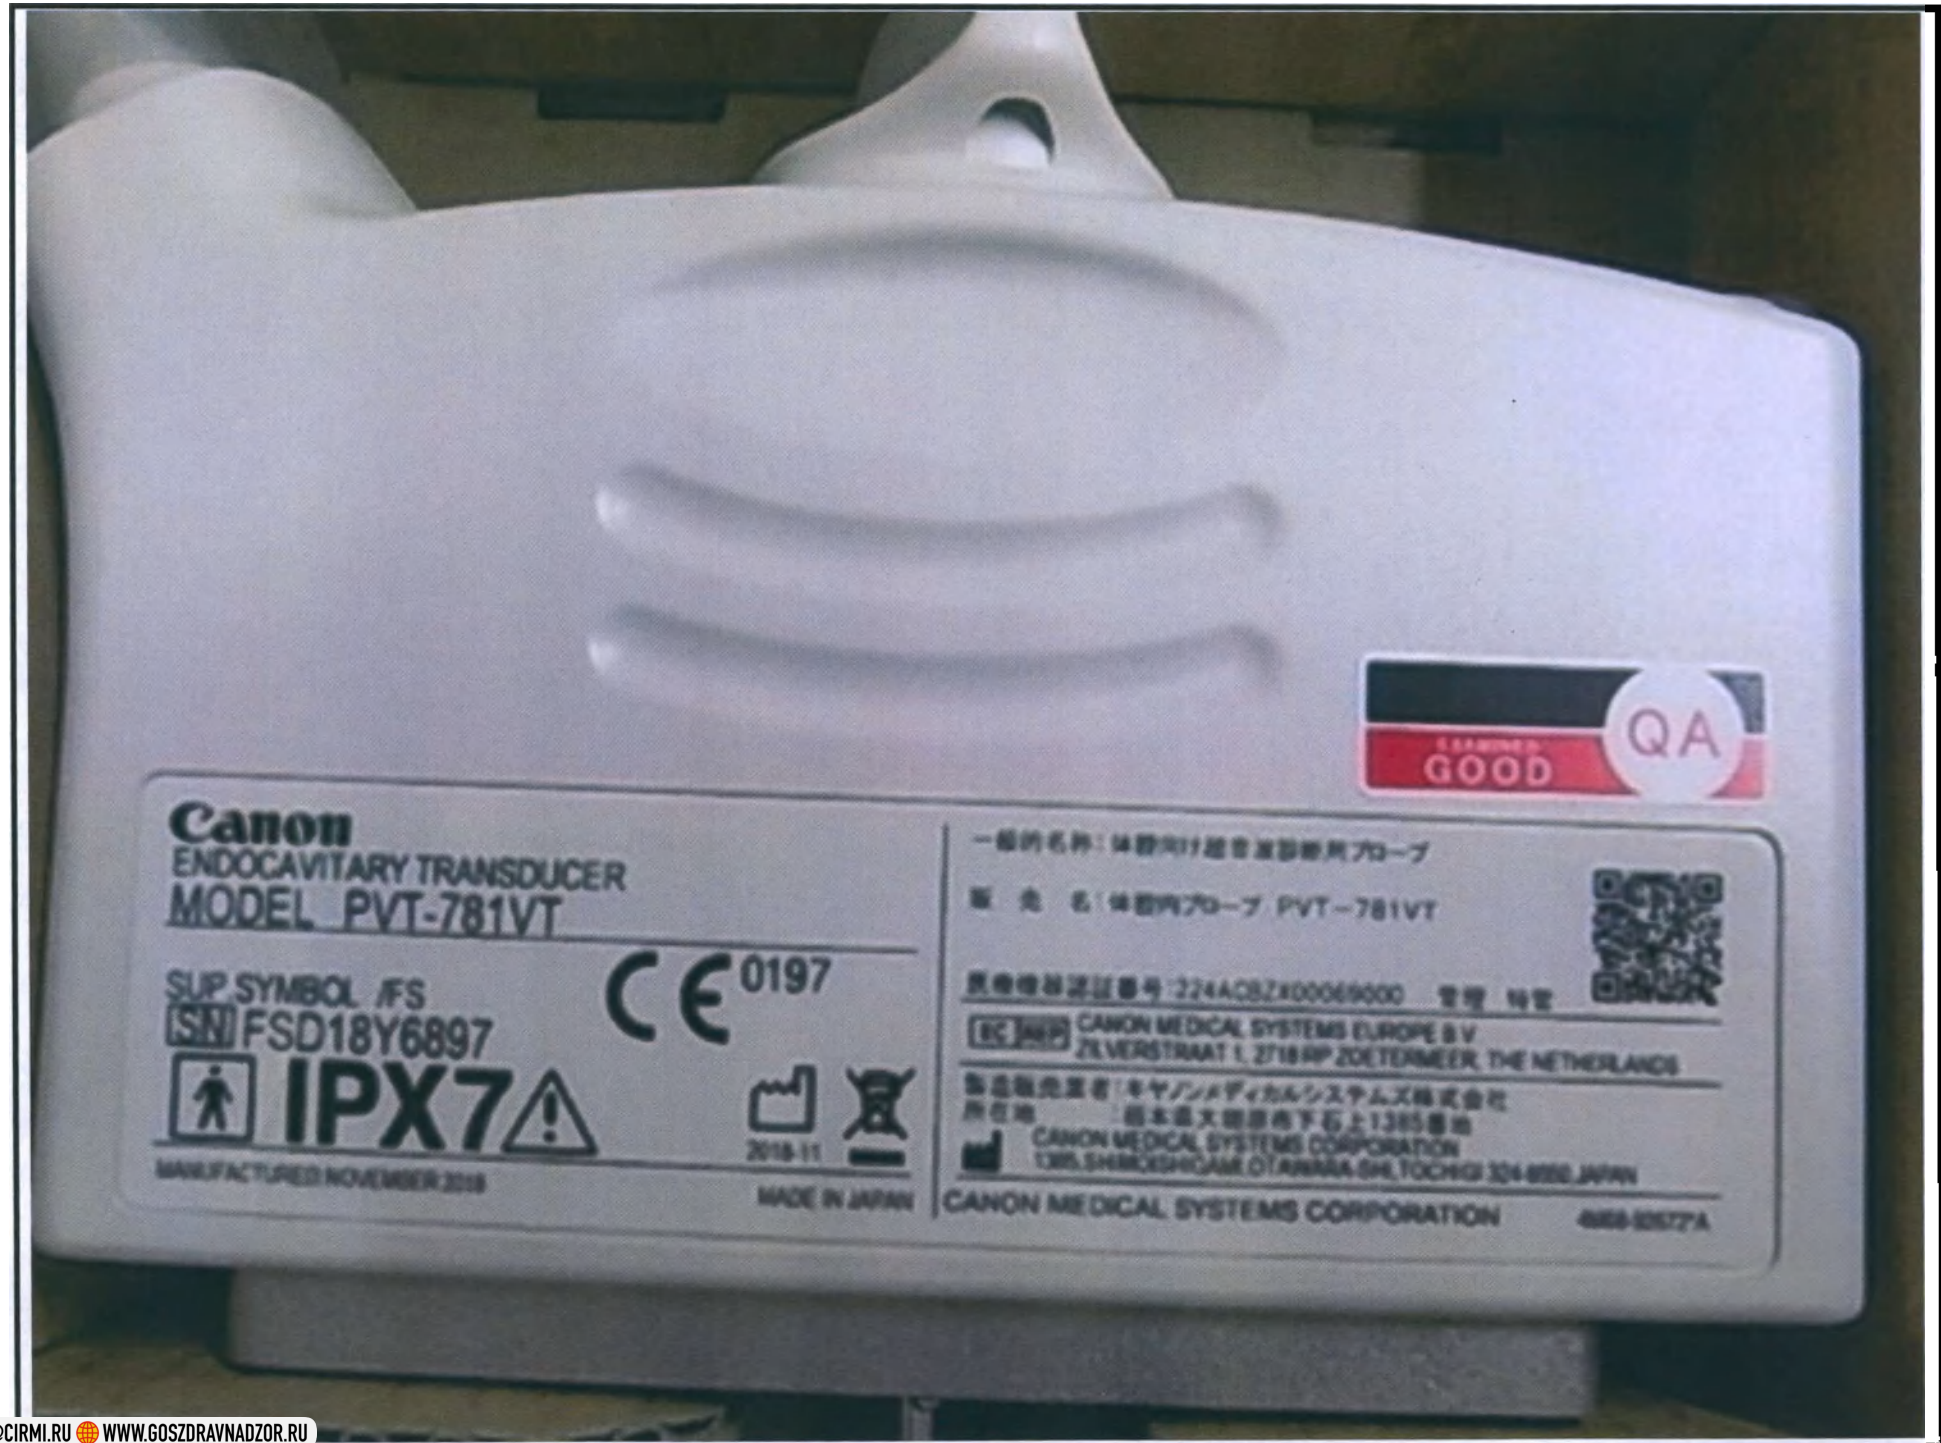



34. Датчик внутриполостной, модель PVT-781VTE, производства Canon Medical Systems Corporation, Япония, РУ № РЗН 2020/11544 (при необходимости)






34. Датчик внутривидеоскопический, модель PVT-781VTE, производства Canon Medical Systems Corporation, Япония, РУ № РЗН 2020/11544 (при необходимости)





34. Датчик внутриполостной, модель PVT-781VTE, производства Canon Medical Systems Corporation, Япония, РУ № РЗН 2020/11544 (при необходимости)

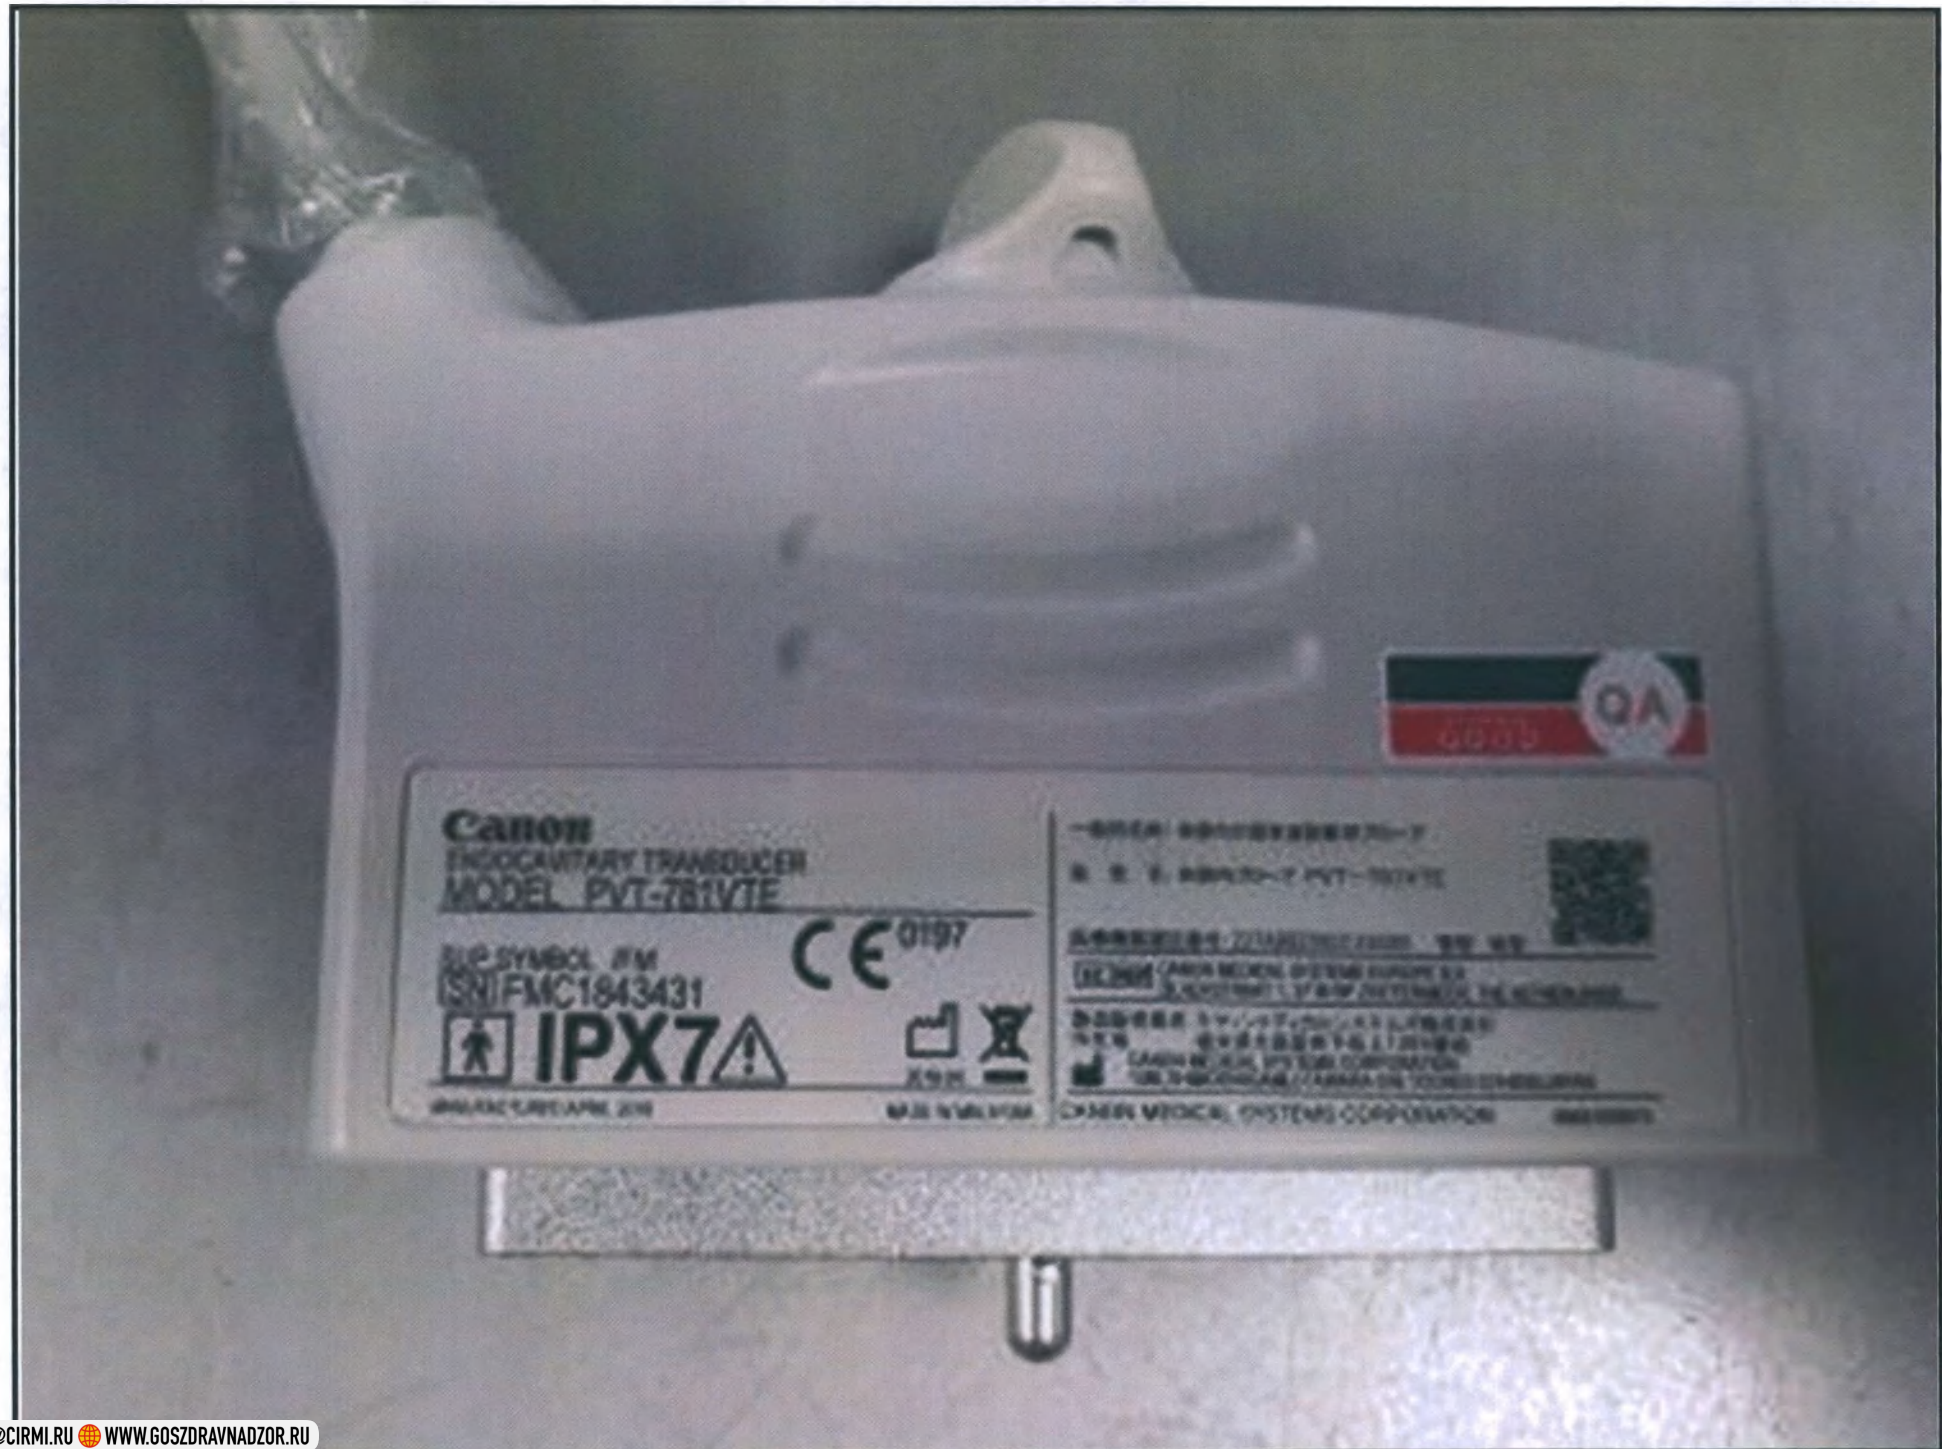



35. Датчик карандашный, модель PC-20M, производства Canon Medical Systems Corporation, Япония, РУ № РЗН 2020/11544 (при необходимости)






35. Датчик карандашный, модель PC-20M, производства Canon Medical Systems Corporation, Япония, РУ № РЗН 2020/11544 (при необходимости)





35. Датчик карандашный, модель PC-20M, производства Canon Medical Systems Corporation, Япония, РУ № РЗН 2020/11544 (при необходимости)

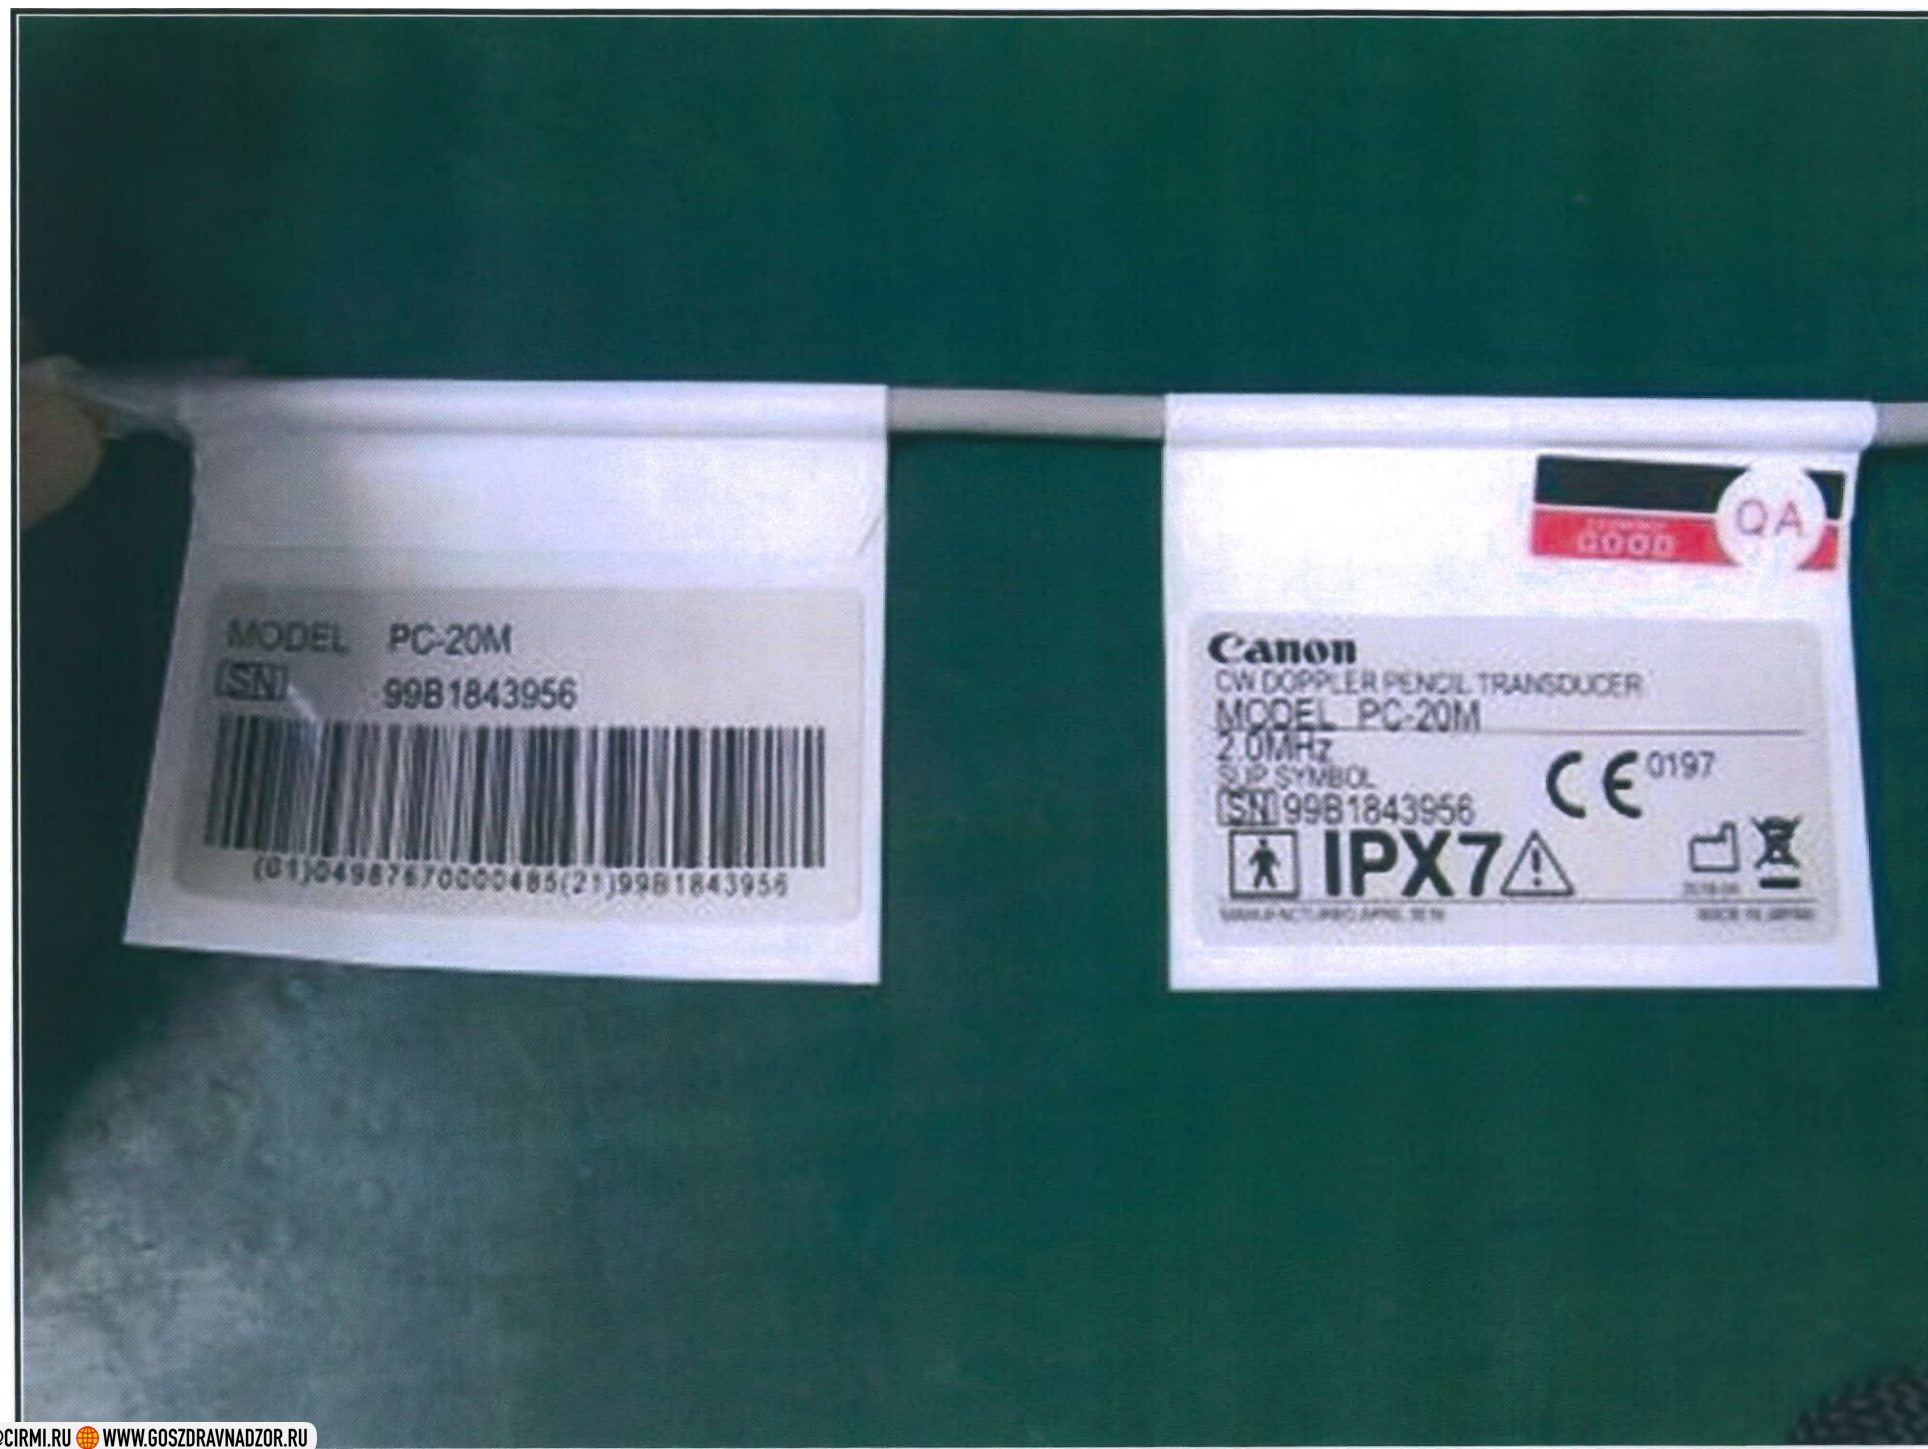



36. Датчик карандашный, модель PC-50M, производства Canon Medical Systems Corporation, Япония, РУ № РЗН 2020/11544 (при необходимости)






36. Датчик карандашный, модель PC-50M, производства Canon Medical Systems Corporation, Япония, РУ № РЗН 2020/11544 (при необходимости)





36. Датчик карандашный, модель PC-50M, производства Canon Medical Systems Corporation, Япония, РУ № РЗН 2020/11544 (при необходимости)

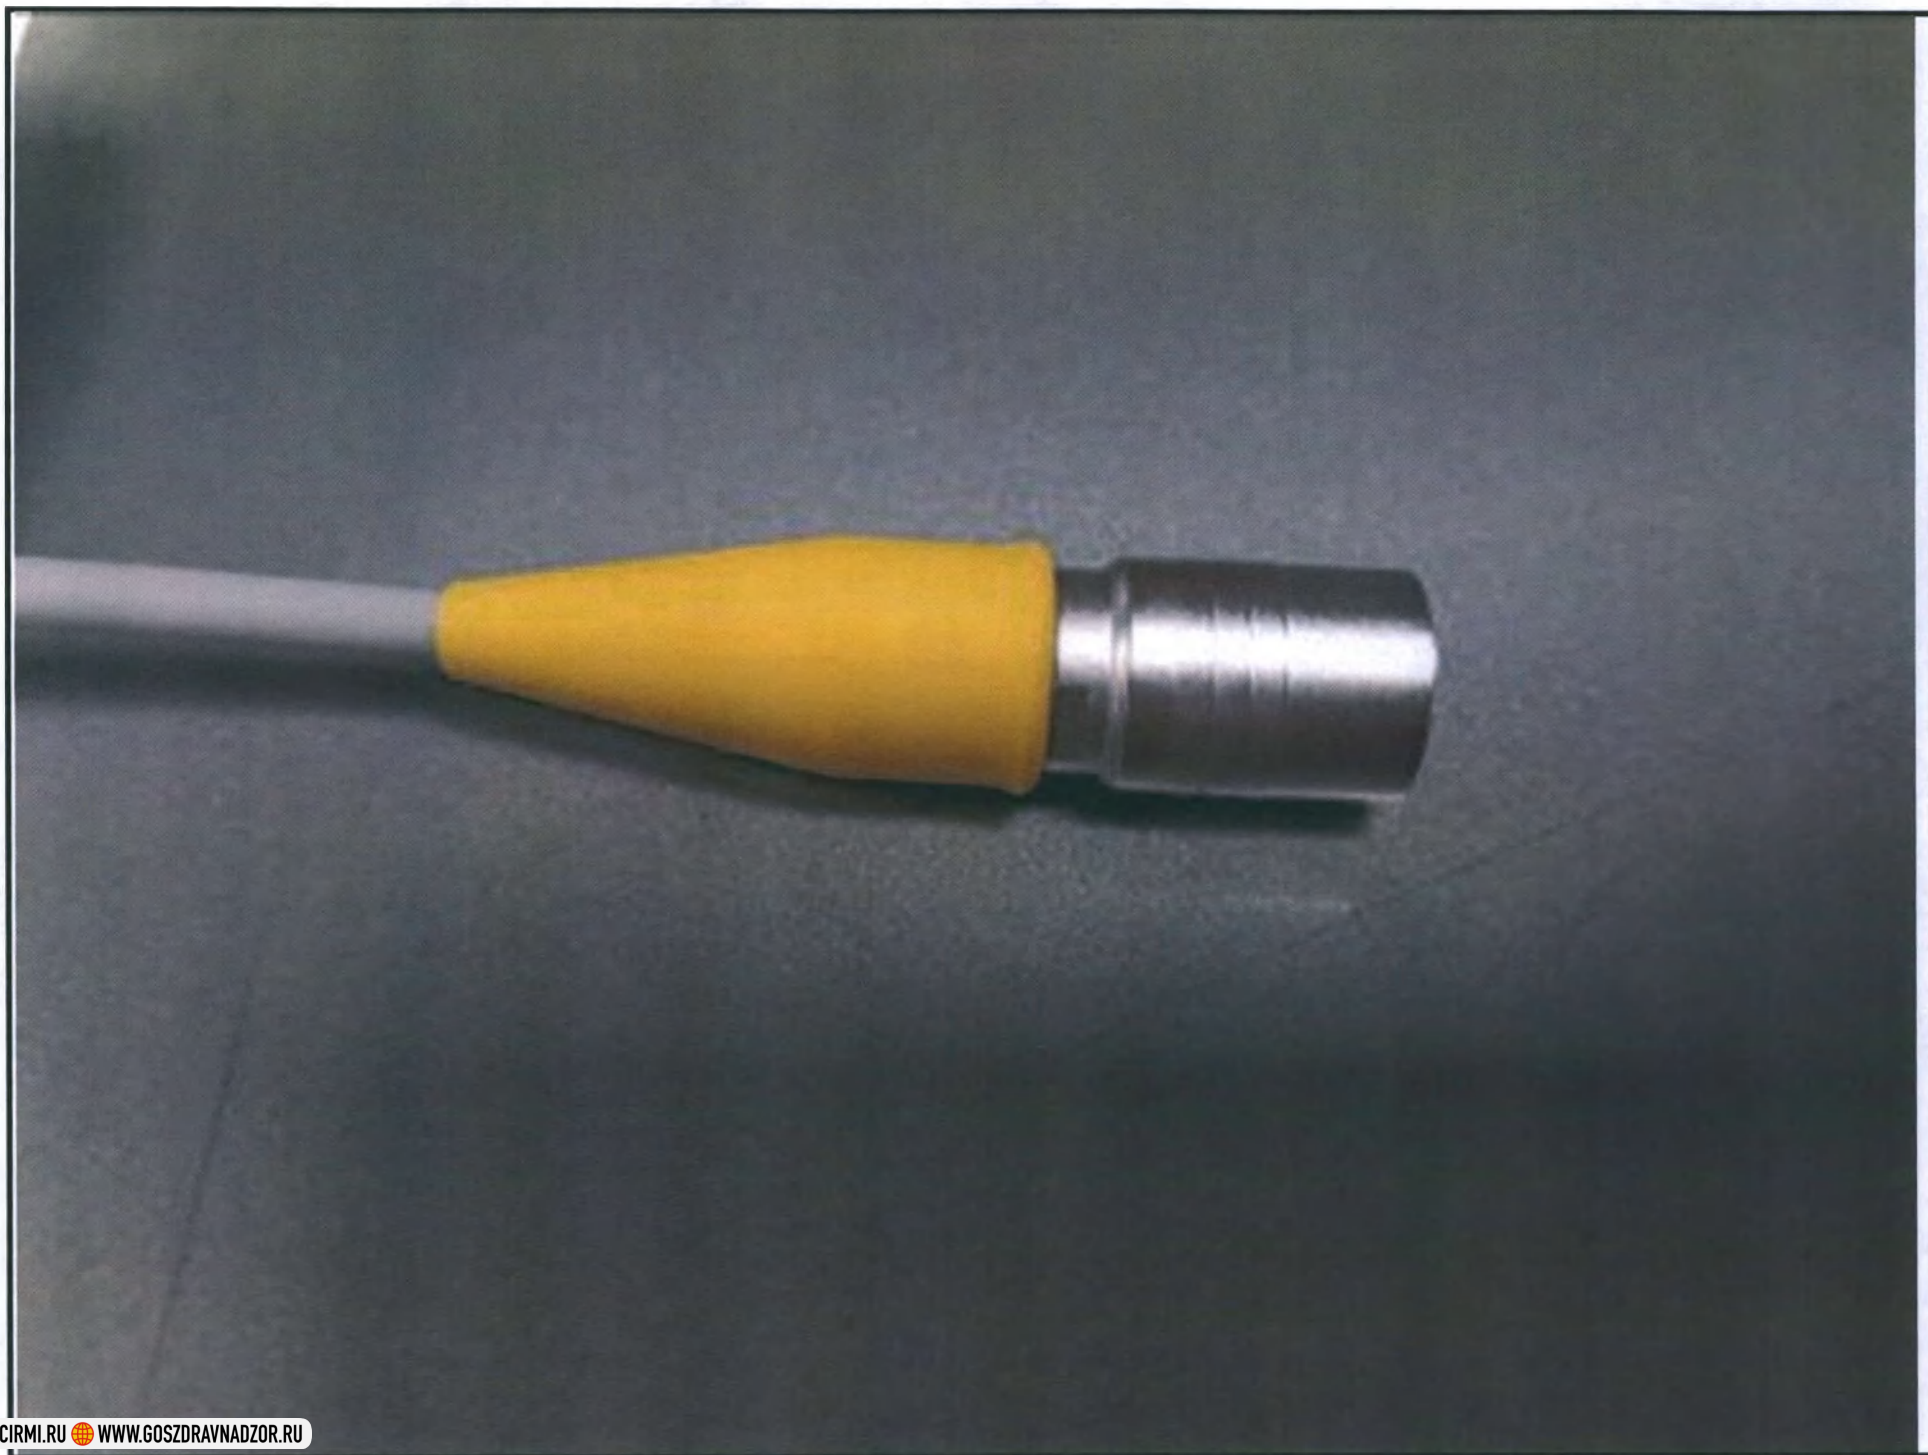



Canon

№ 2B771-587 RU

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ СИСТЕМЫ

***Aplio a550/Aplio a450*****МОДЕЛИ CUS-AA550/CUS-AA450****[ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ]****(2B771-587 RU)****УВЕДОМЛЕНИЕ**

Федеральный закон США ограничивает продажу и использование данного изделия врачом или по его указанию.

**ВАЖНО!**

Прежде чем приступать к эксплуатации оборудования, следует внимательно ознакомиться с настоящим руководством по эксплуатации. После прочтения храните данное руководство в легкодоступном месте.

CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION

© CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION 2022

ВСЕ ПРАВА СОХРАНЕНЫ

Опубликовано: 03-2022




## 38. Кабель питания





Принадлежности: 1. Программное приложение для постоянно-волнового доплера (CW)

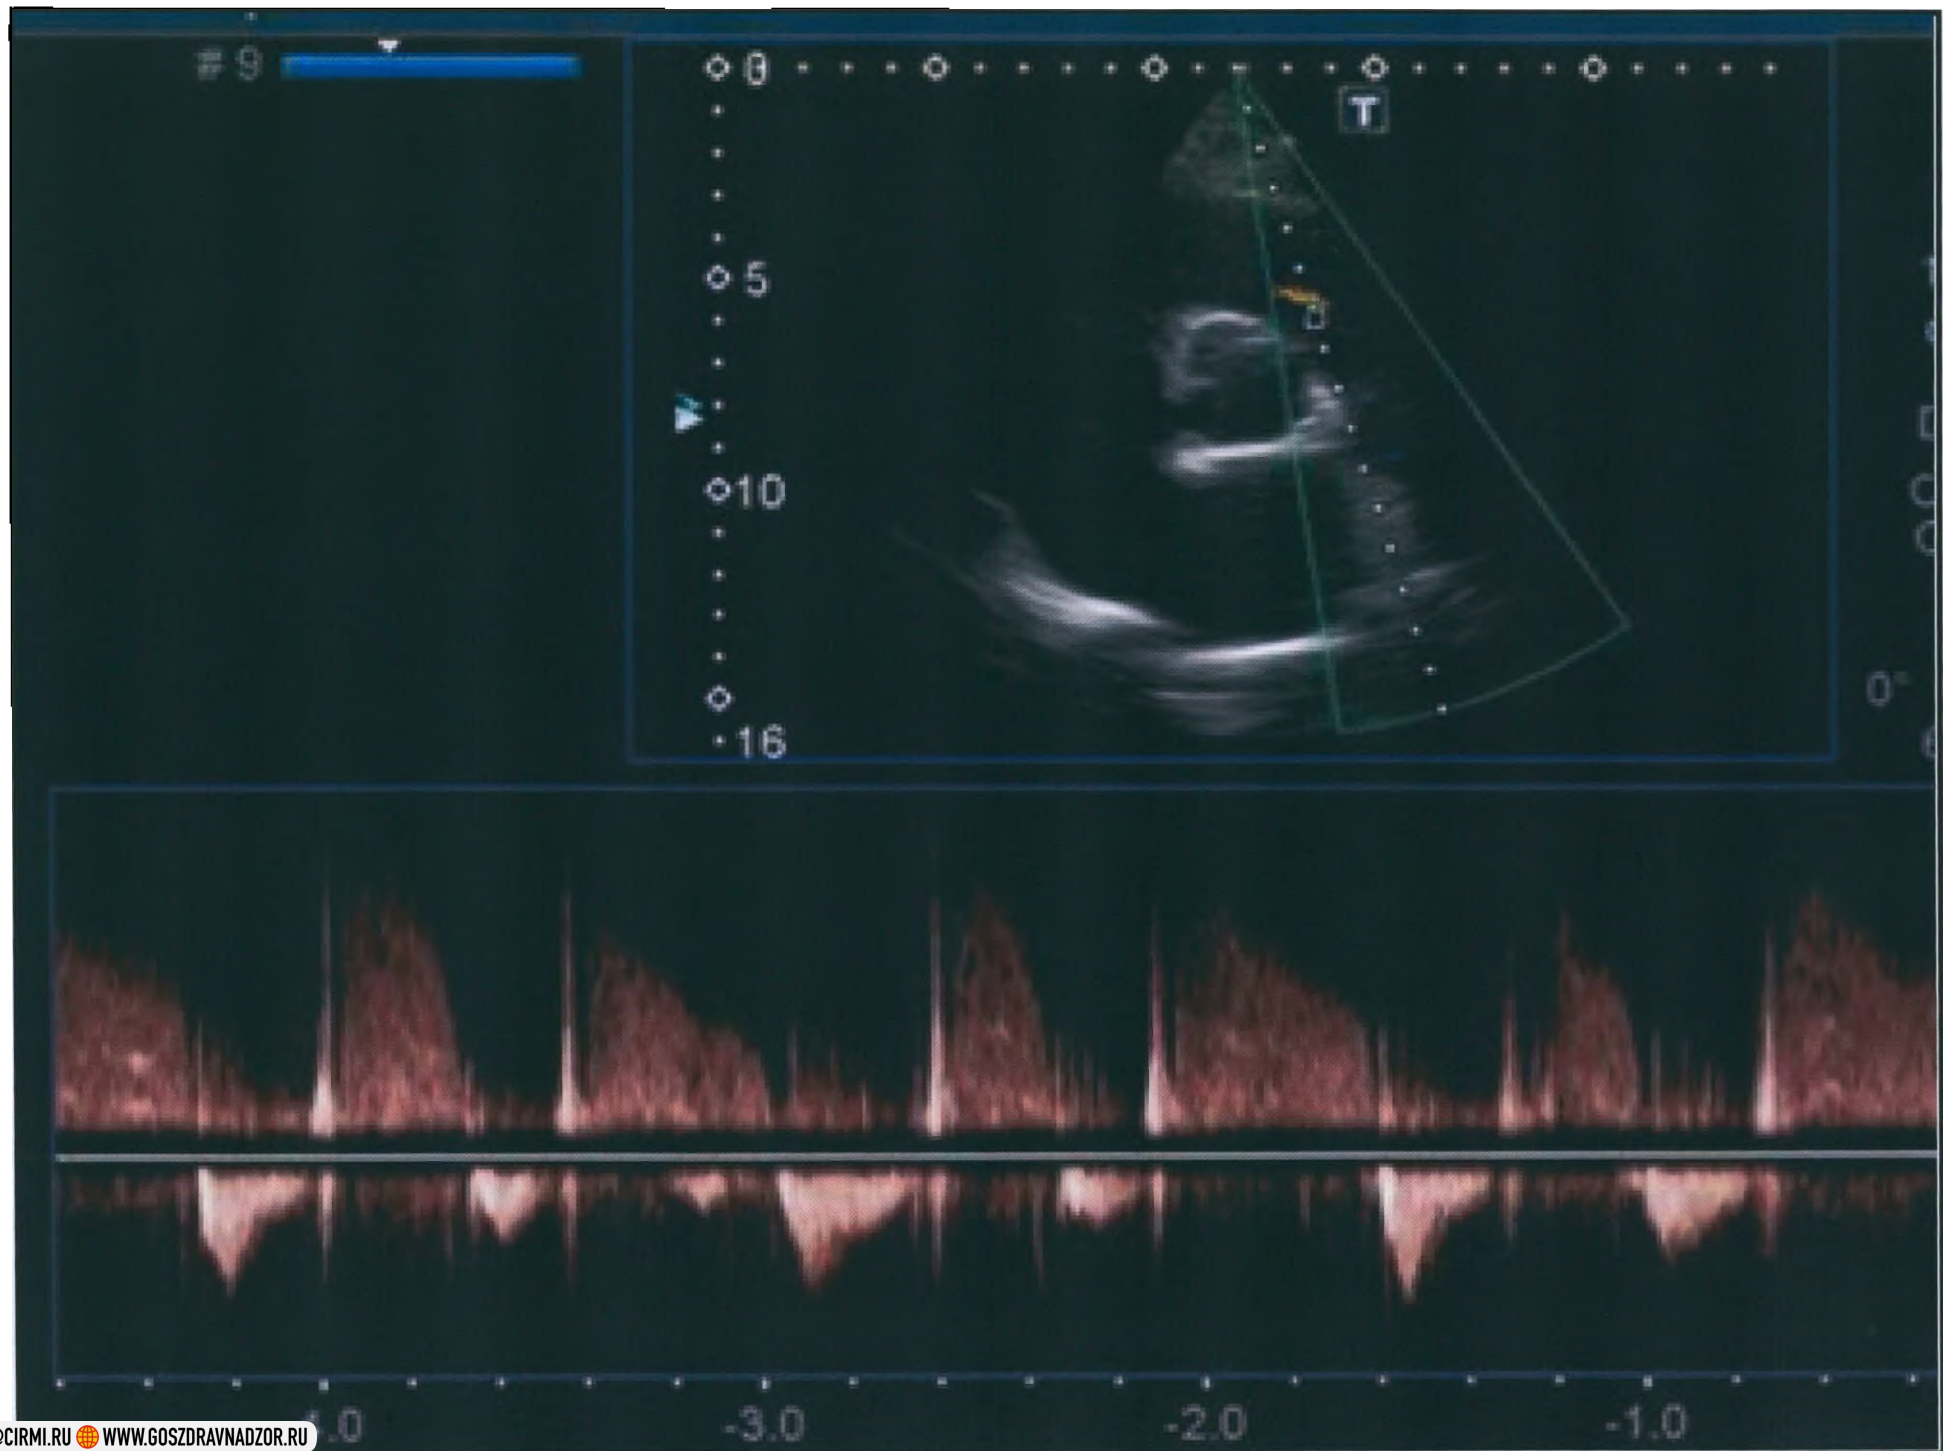




2. Программное приложение для отображения референсных сигналов (ЭКГ)






### 3. Кабель референсного сигнала

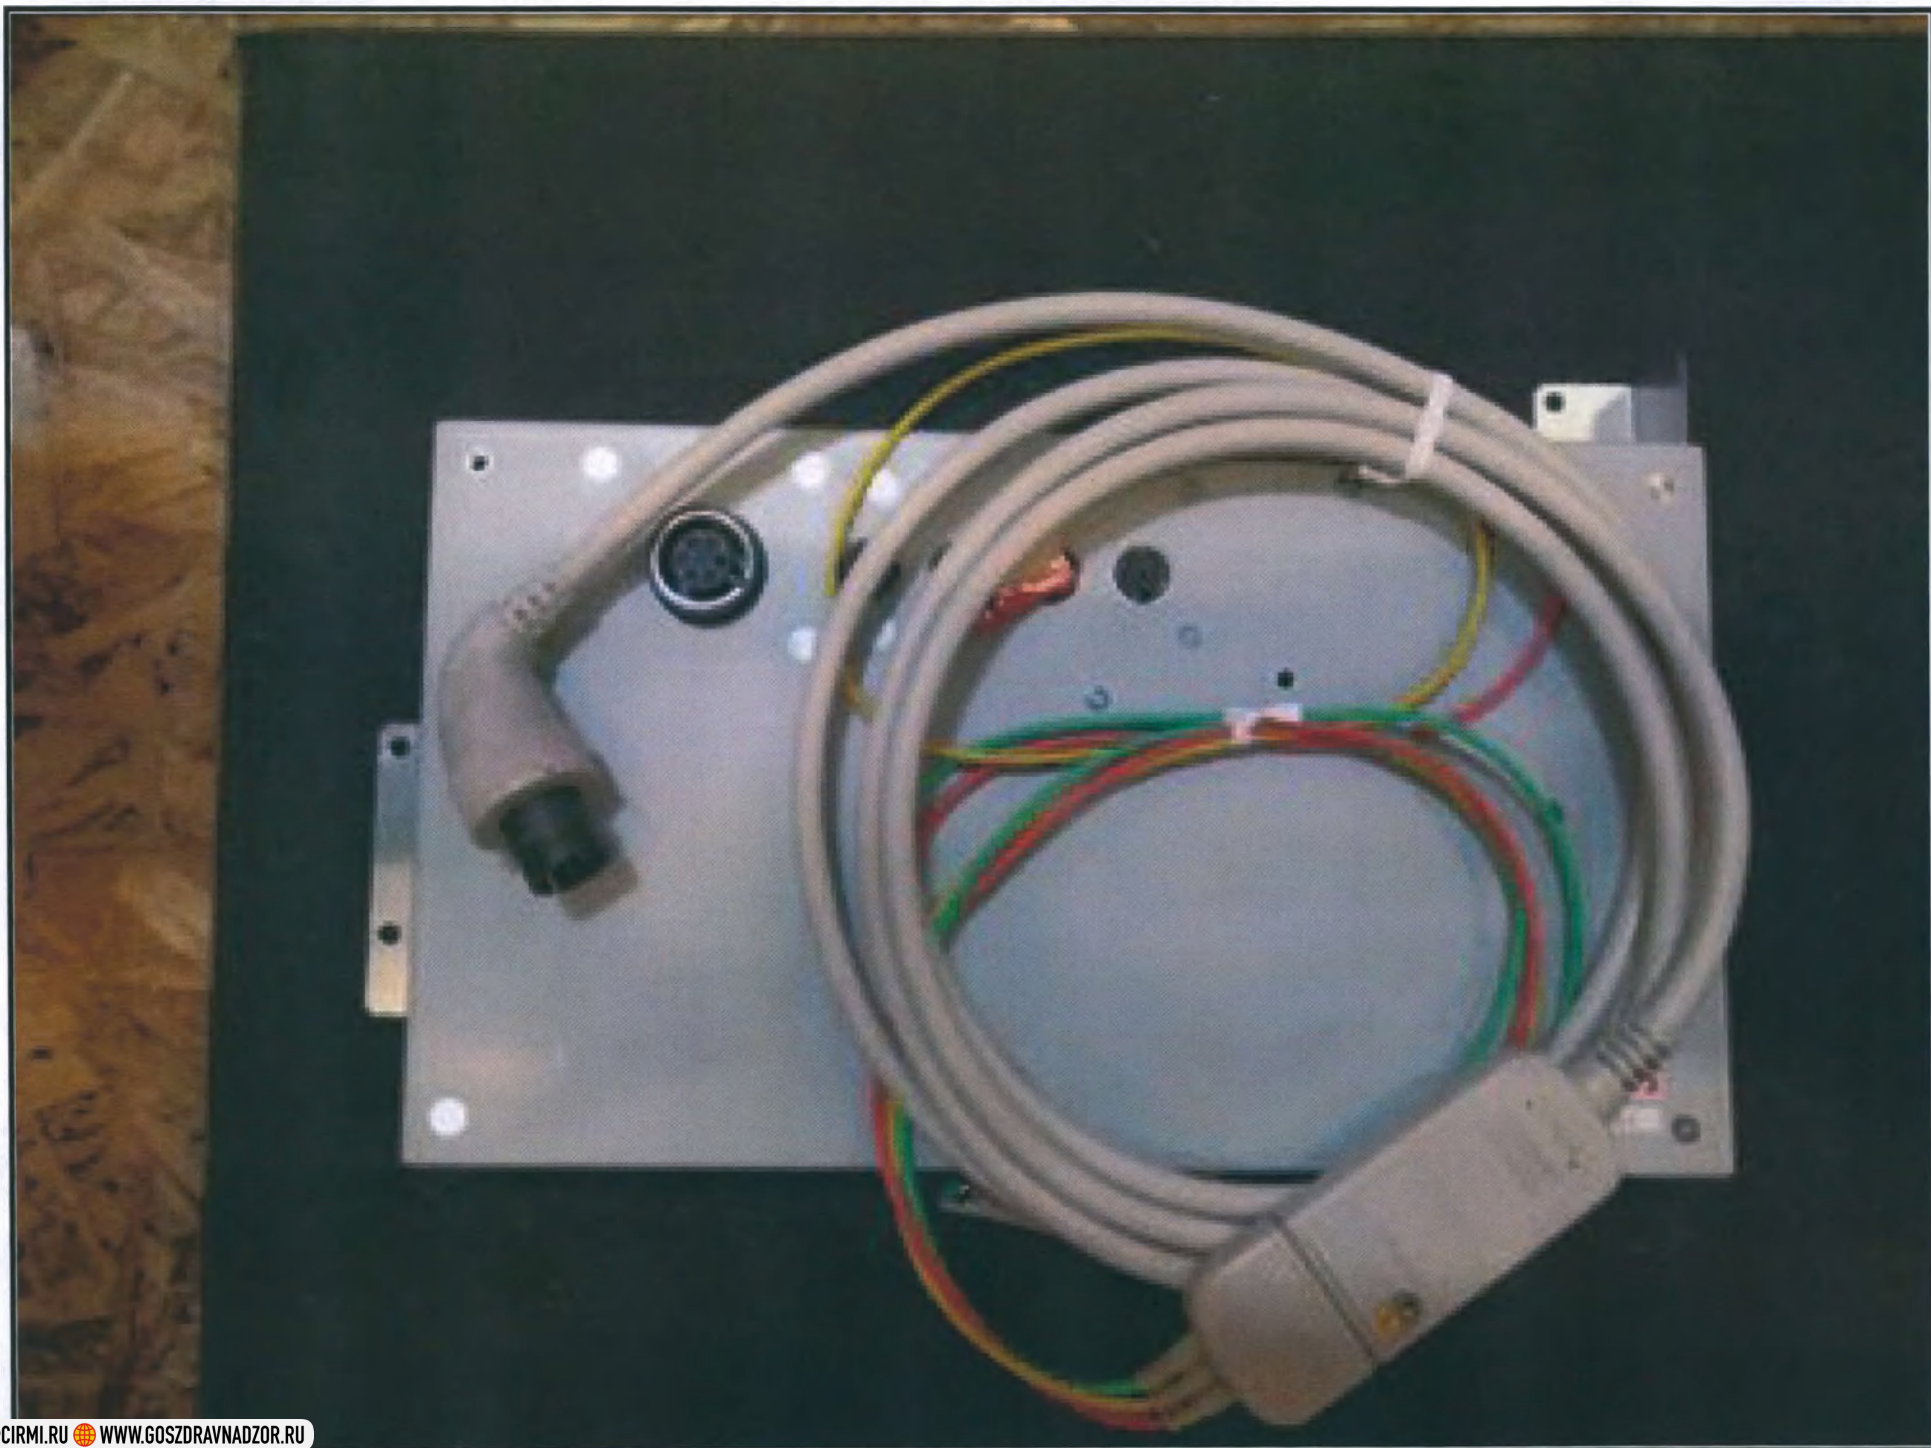



4. Программное приложение для стресс-эхокардиографии (Stress Echo)

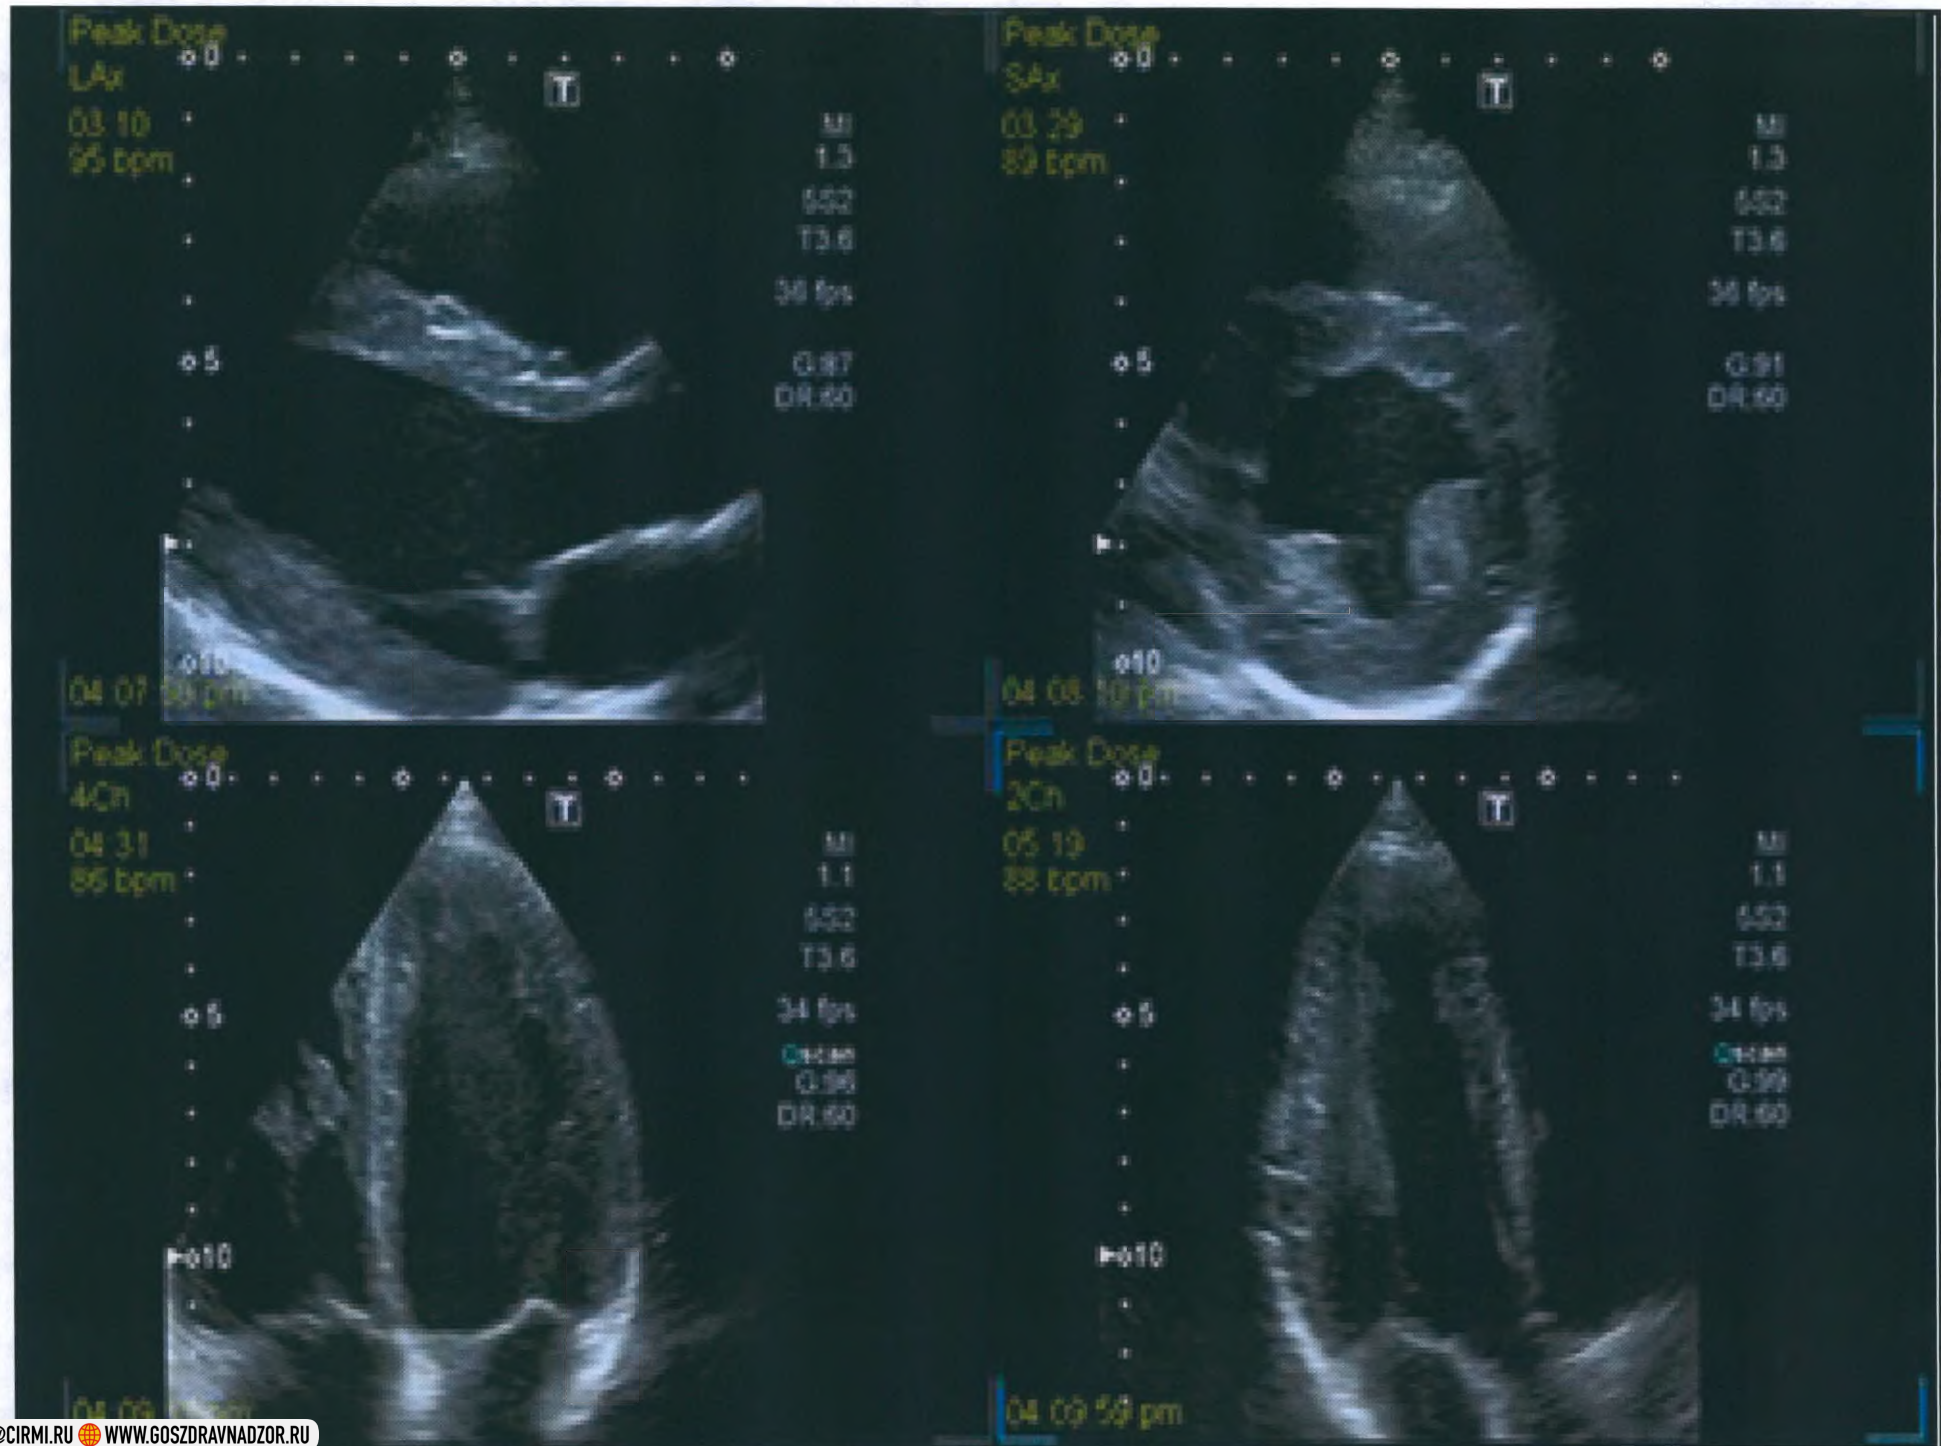




5. Программное приложение для отслеживания движения стенок миокарда в 2D режиме (2D Wall Motion Tracking)





6. Программное приложение для автоматического измерения фракции выброса (Auto EF Measurement)

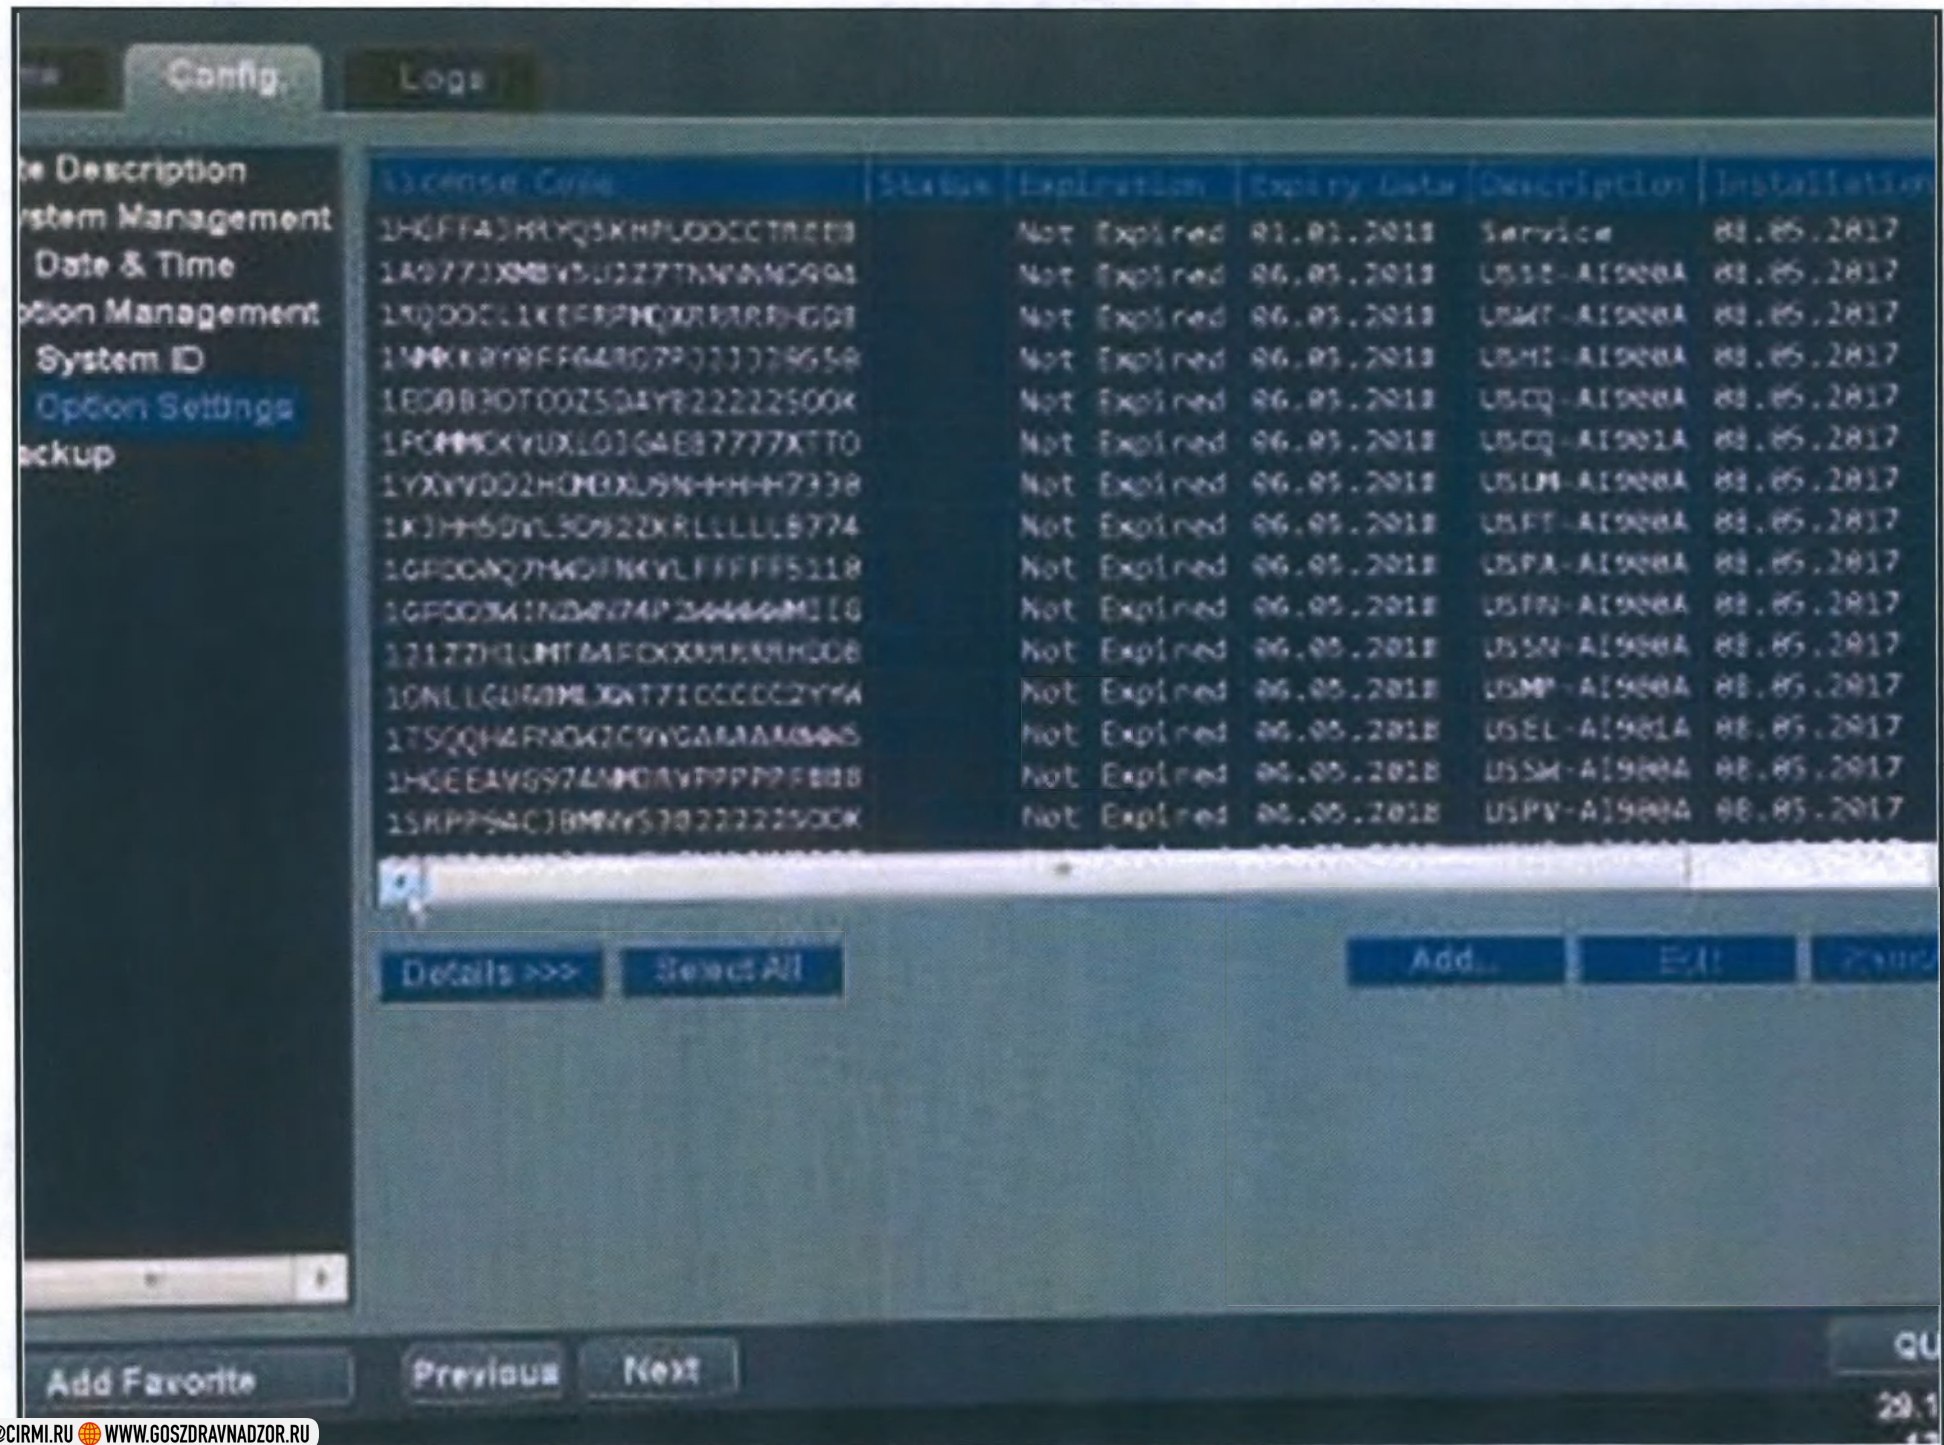




7. Модуль подключения карандашного датчика





8. Держатель для датчика транспищеводного мультипланового

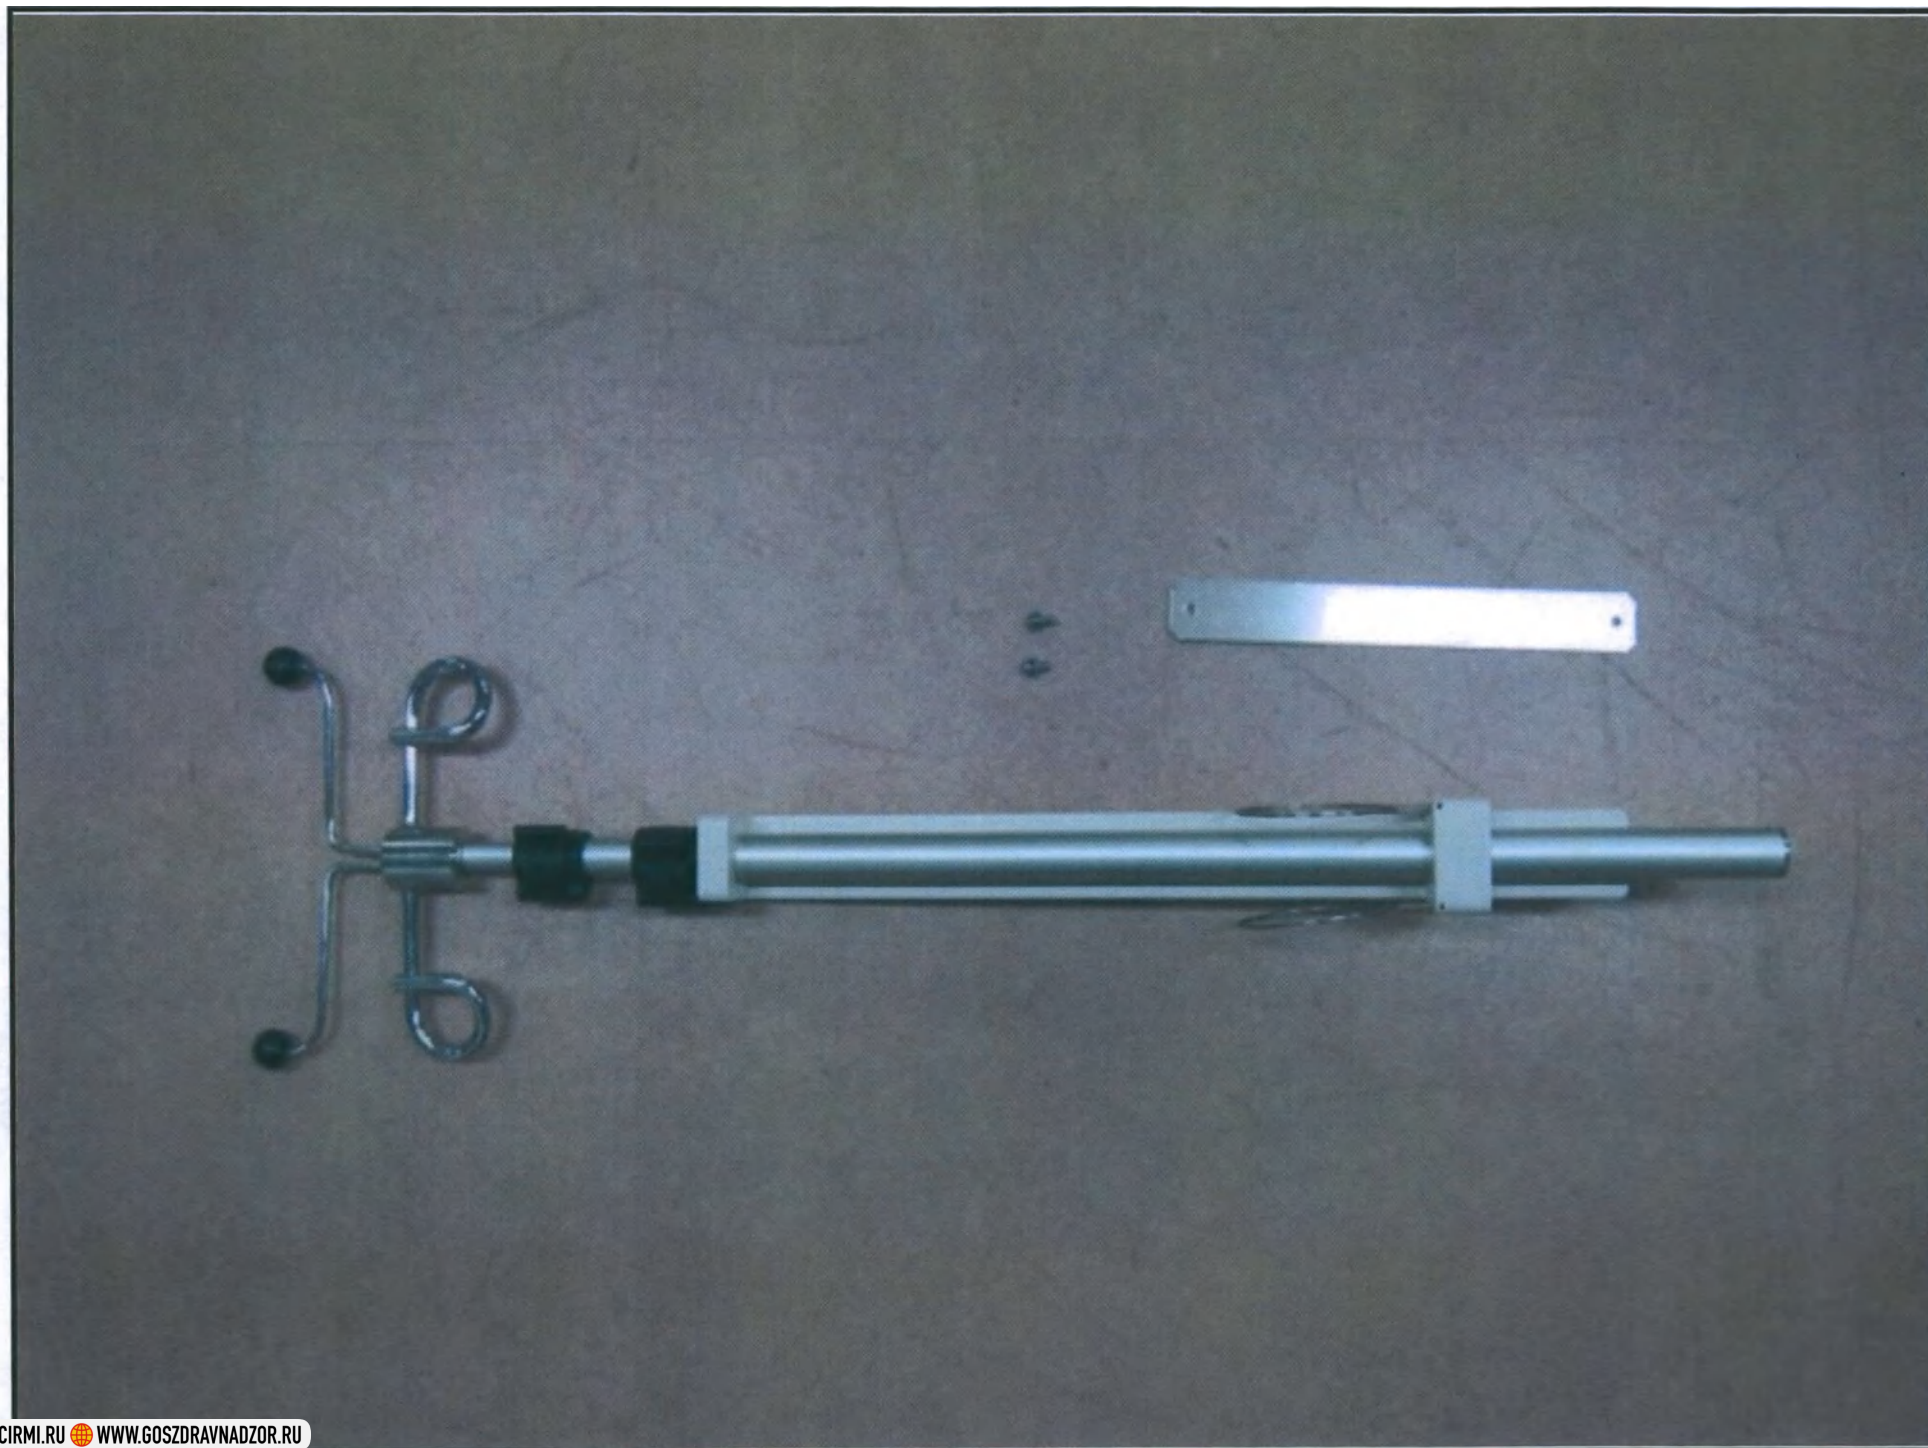



9. Модуль специализированный кардио-сосудистый (CV)

**Наклейка на блок  
системы - 2 шт.**



**Наклейка на  
монитор - 1 шт.**






10. Модуль регулятора STC на панели управления






11. Программное приложение для исследования с контрастами (СНП)

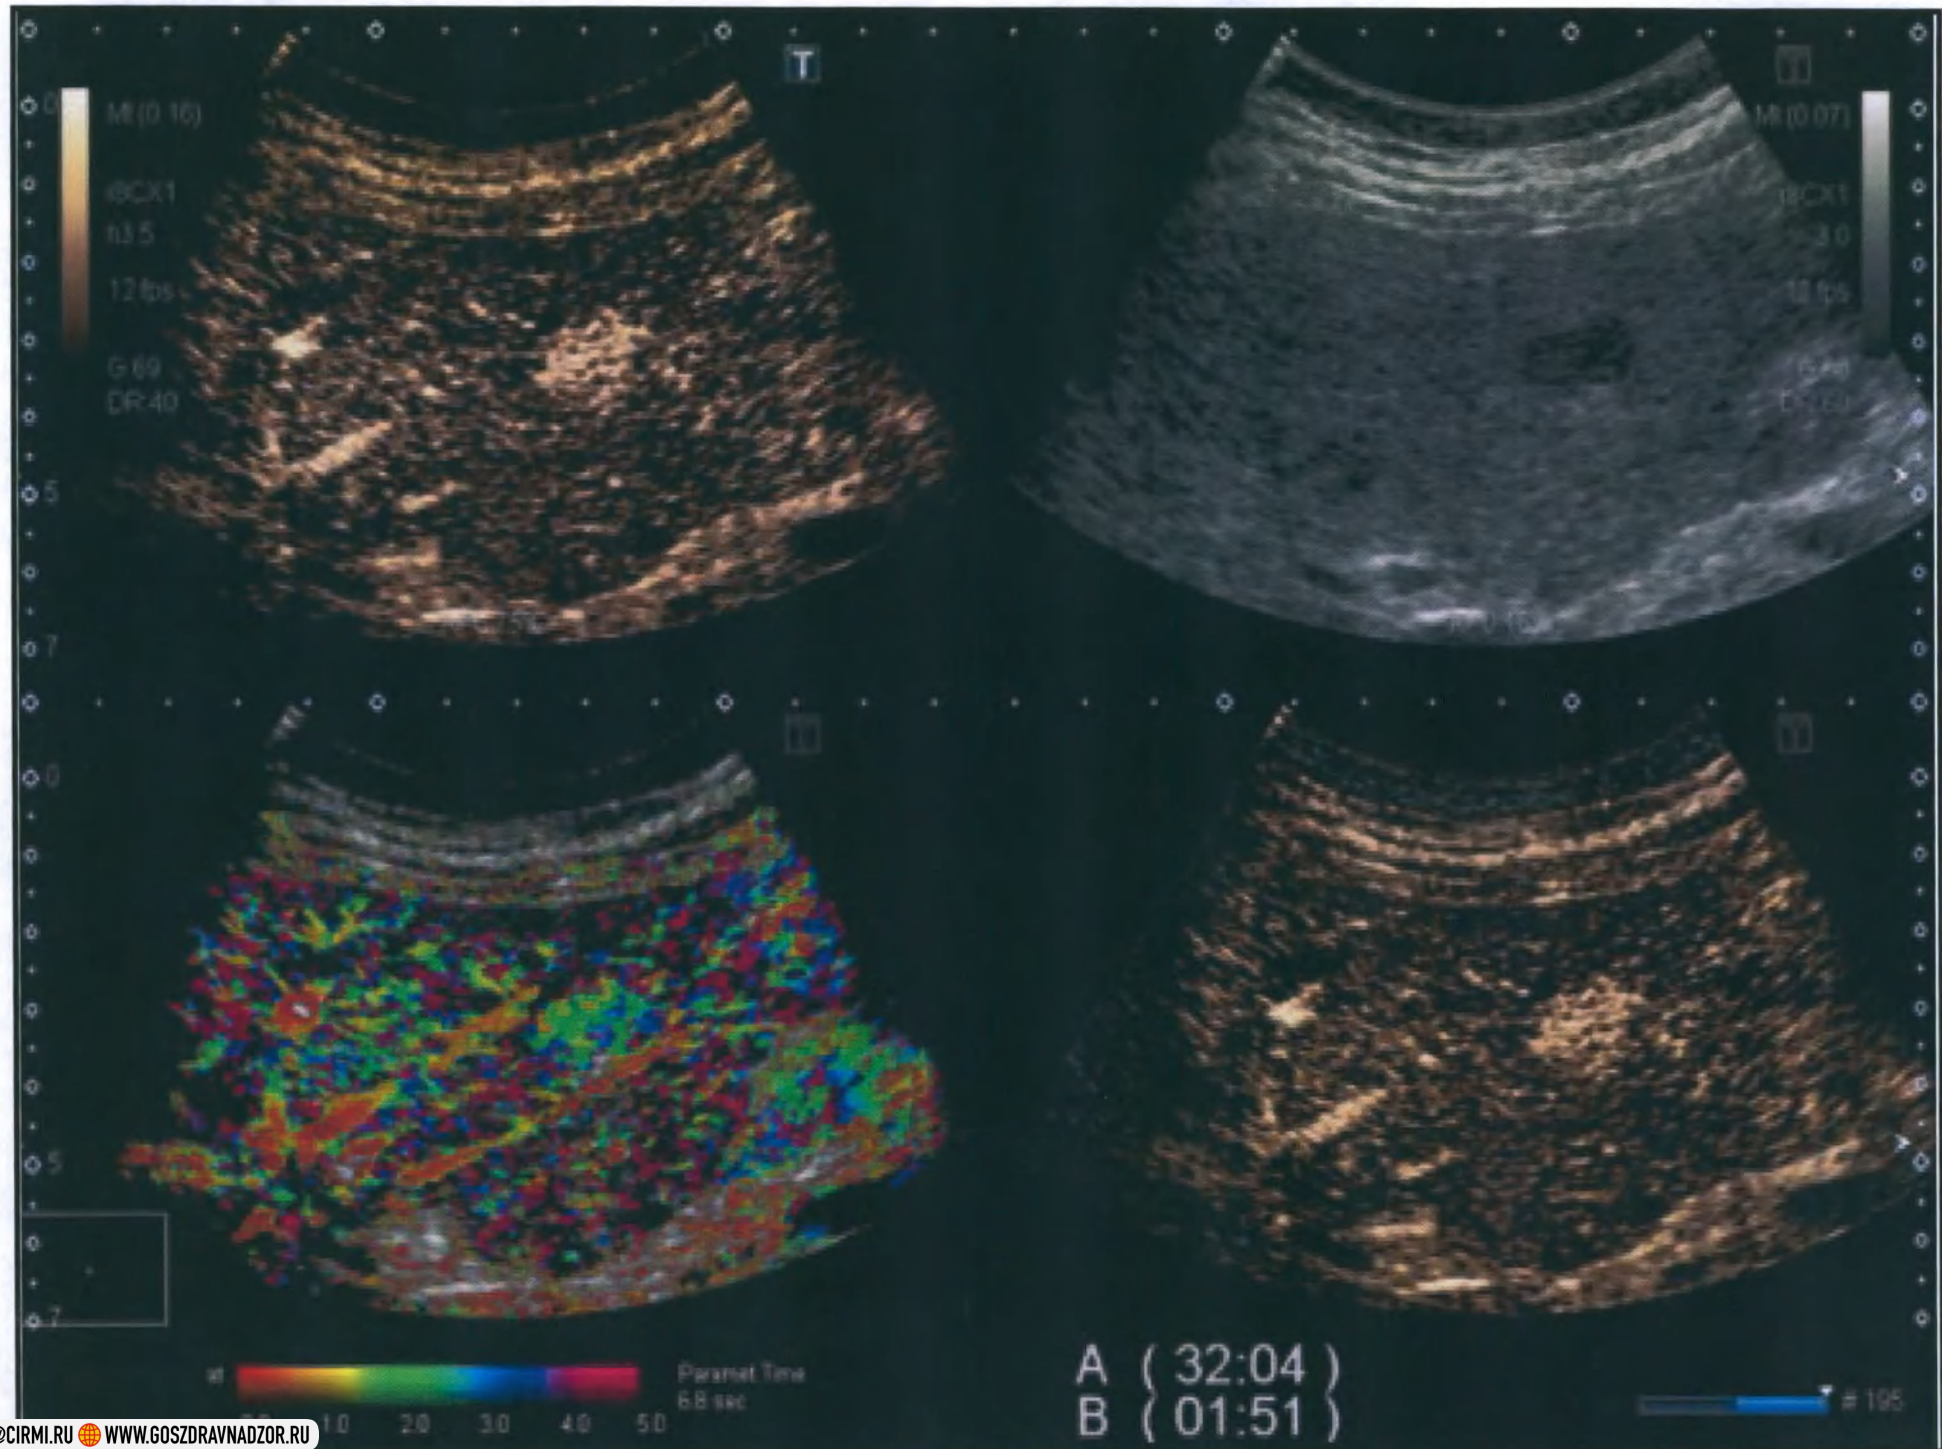




12. Программное приложение для количественного анализа в режиме контрастной эхографии (CHI-Q) (только для варианта исполнения Aplio a350 (модель CUS-AA550))

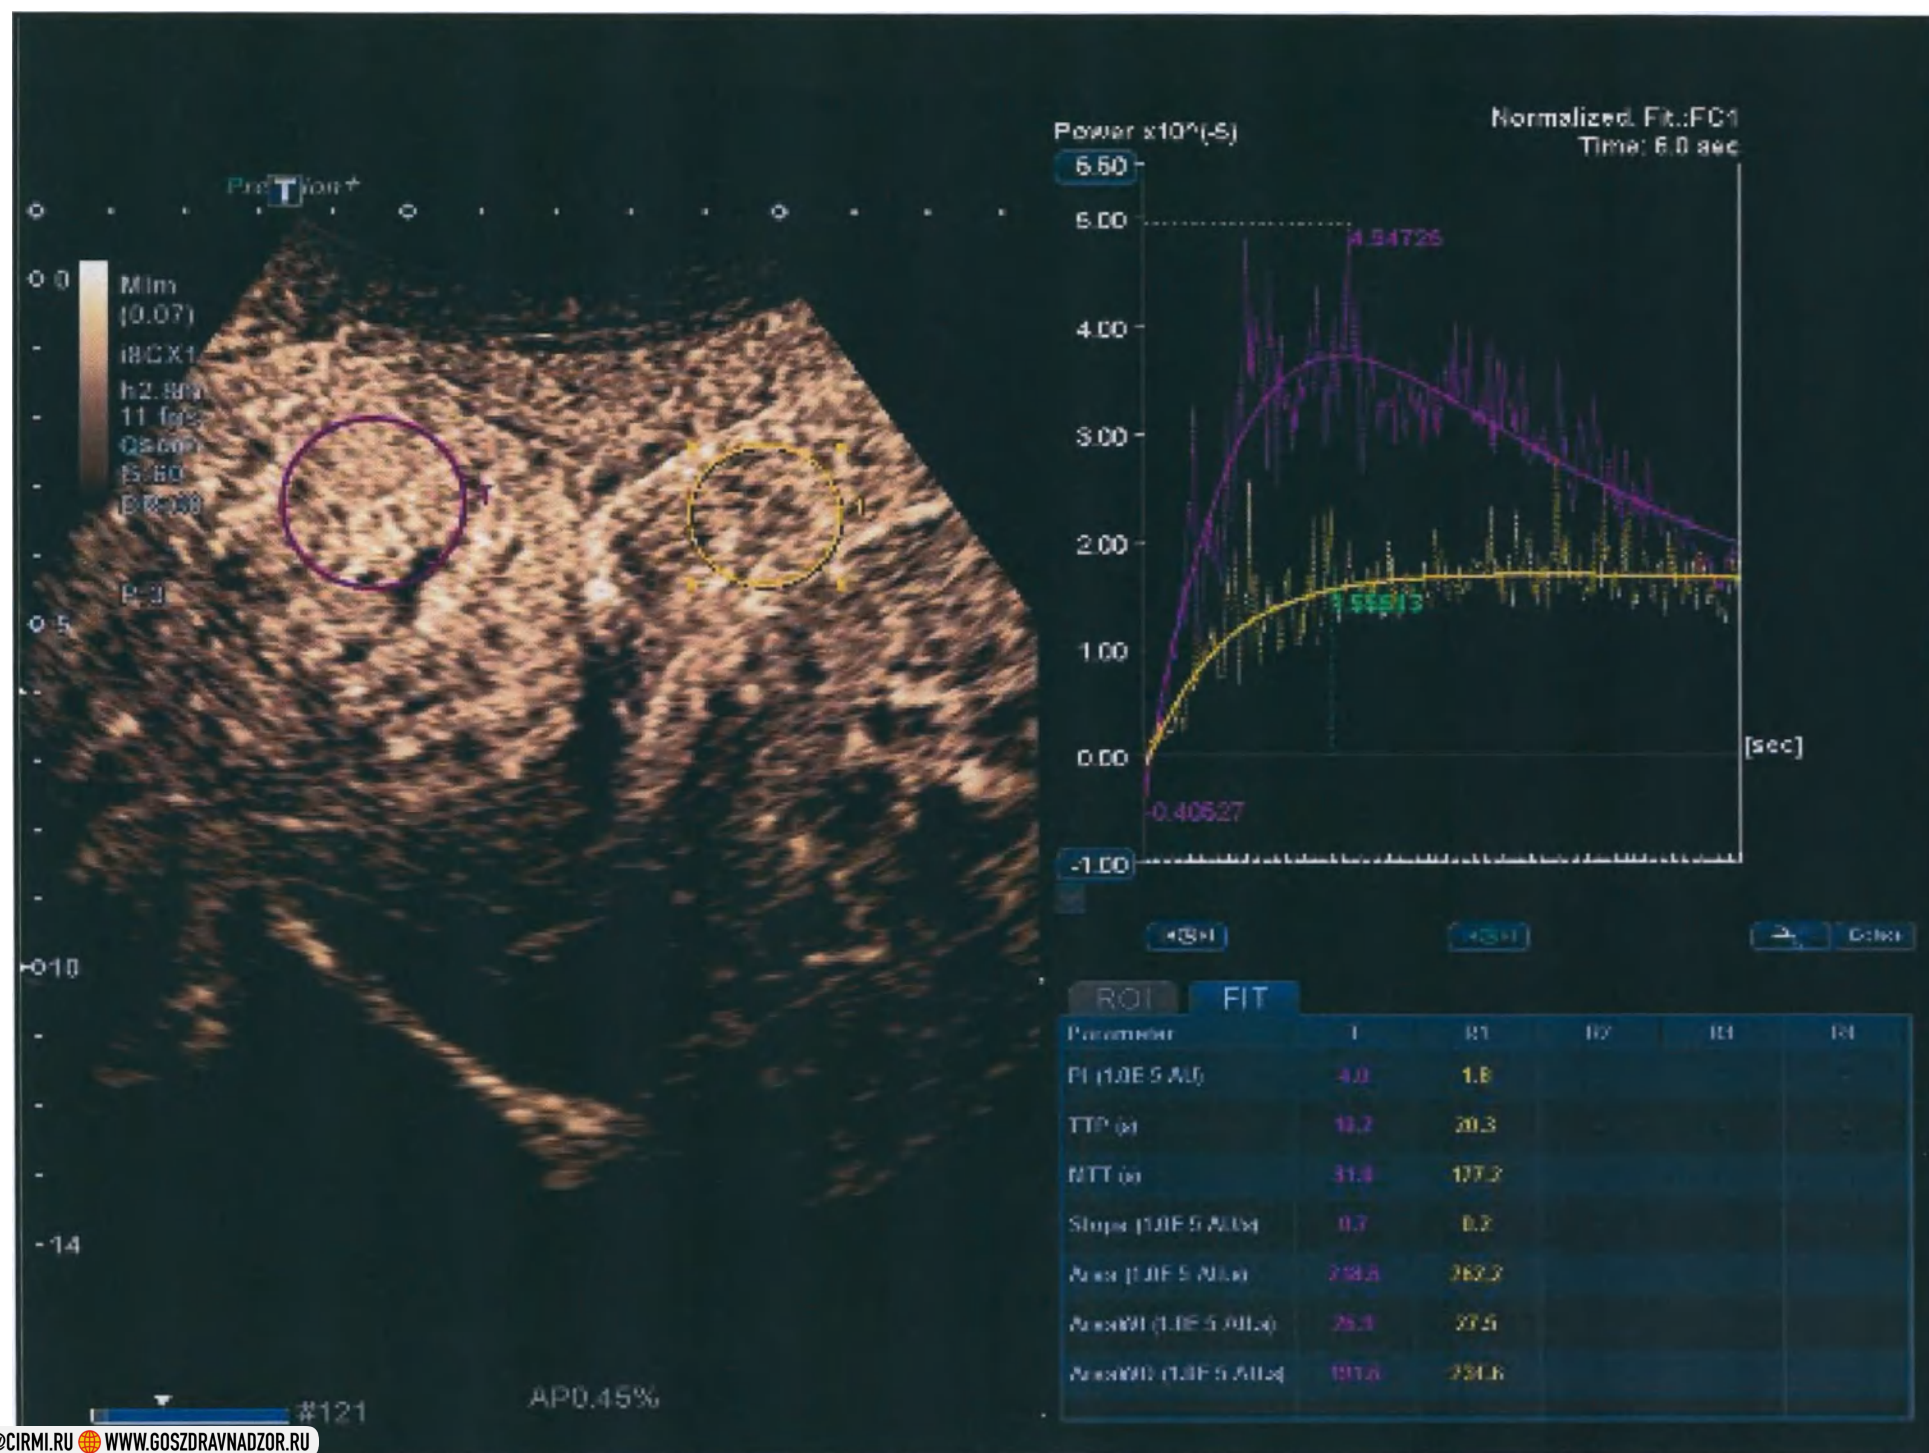



13. Программное приложение для аппроксимации кривой (Fitting Curve) (только для варианта исполнения Aplio a550(модель CUS-AA550))

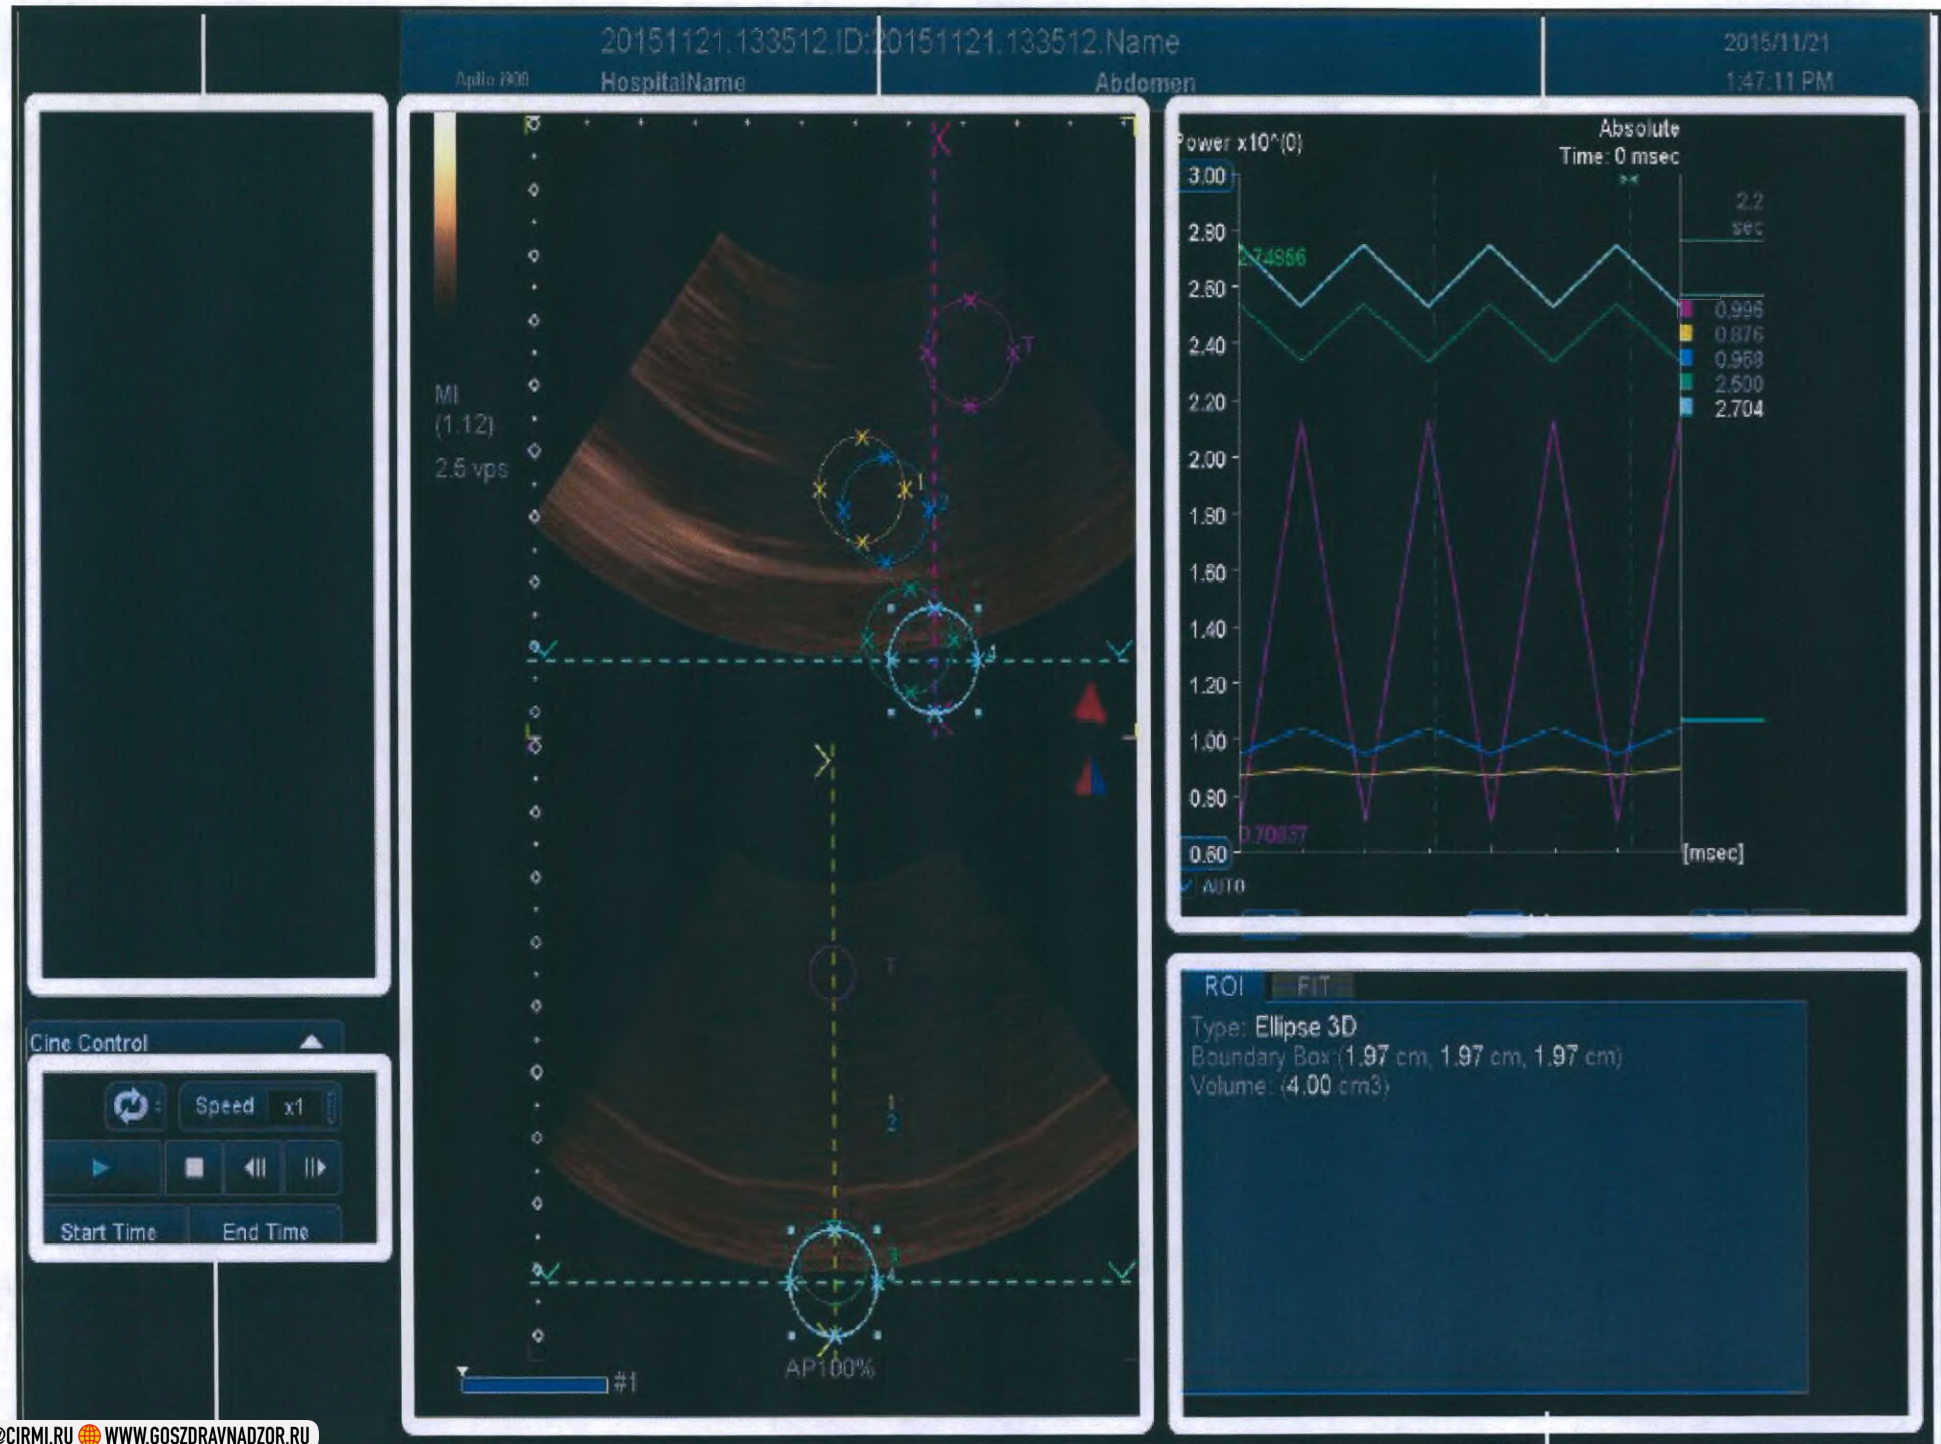



The screenshot shows the MikroTik WinBox interface with the 'Config' tab selected. A 'License Management' window is open, displaying a table of licenses. The table has the following columns: License Code, Status, Expiration, Expiry Date, Description, and Installation Date. The licenses listed are:

| License Code               | Status      | Expiration | Expiry Date | Description | Installation Date |
|----------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------------|
| 1HGF43HKYQ5KHPL000CTREB8   | Not Expired | 01.01.2018 | 06.05.2018  | Service     | 01.05.2017        |
| 1A9773XMBV5U227TNWVND994   | Not Expired | 06.05.2018 | 06.05.2018  | US12-A1900A | 01.05.2017        |
| 1XQ00CL1KEFPN0XRPRRFG08    | Not Expired | 06.05.2018 | 06.05.2018  | USMT-A1900A | 01.05.2017        |
| 1MVKRY8FF648G7P333229658   | Not Expired | 06.05.2018 | 06.05.2018  | USHI-A1900A | 01.05.2017        |
| 1E00B3OT00Z5DAY822222500K  | Not Expired | 06.05.2018 | 06.05.2018  | USCQ-A1900A | 01.05.2017        |
| 1PCHMKYUXL03G4B8777XFT0    | Not Expired | 06.05.2018 | 06.05.2018  | USCQ-A1901A | 01.05.2017        |
| 1YXVVD02HCHXU9N-HH-H7338   | Not Expired | 06.05.2018 | 06.05.2018  | USLM-A1900A | 01.05.2017        |
| 1K3HH6DVL30922XRLULLLB774  | Not Expired | 06.05.2018 | 06.05.2018  | USFT-A1900A | 01.05.2017        |
| 1GPDQNZ7H4DIFNKVLF555118   | Not Expired | 06.05.2018 | 06.05.2018  | USPA-A1900A | 01.05.2017        |
| 1GPDQNM1N34K74P34444MI16   | Not Expired | 06.05.2018 | 06.05.2018  | USFM-A1900A | 01.05.2017        |
| 12127H1UMT6MFOXXMKAUHQ08   | Not Expired | 06.05.2018 | 06.05.2018  | US5N-A1900A | 01.05.2017        |
| 10NLLGUS0ML3GAT710CC0C2YFA | Not Expired | 06.05.2018 | 06.05.2018  | USMP-A1900A | 01.05.2017        |
| 1TSQCH4FNQK7C9VGAAMAABW5   | Not Expired | 06.05.2018 | 06.05.2018  | USEL-A1901A | 01.05.2017        |
| 1HGEEMV6974M0RVPPPPF888    | Not Expired | 06.05.2018 | 06.05.2018  | USSW-A1900A | 01.05.2017        |
| 15RPP64C3BMV57022222500K   | Not Expired | 06.05.2018 | 06.05.2018  | USPV-A1900A | 01.05.2017        |

At the bottom of the window, there are buttons for 'Details >>>', 'Select All', 'Add...', 'Edit', and 'Remove...'. The bottom of the WinBox interface shows a sidebar with navigation options: 'Home', 'Config', 'Logs', 'Site Description', 'System Management', 'Date & Time', 'Option Management', 'System ID', 'Option Settings', and 'Backup'. At the very bottom, there are buttons for 'Add Favorite', 'Previous', 'Next', 'QUIT', and a date/time display showing '29.11.2017 17:01:10'.



15. Программное приложение для виртуального освещения (Luminance)






16. Программное приложение для виртуального затенения (Shadow Glass) (только для варианта исполнения Aplio a550(модель CUS-AA550))





17. Программное приложение для автоматического измерения объема (Auto Volume Measurement)

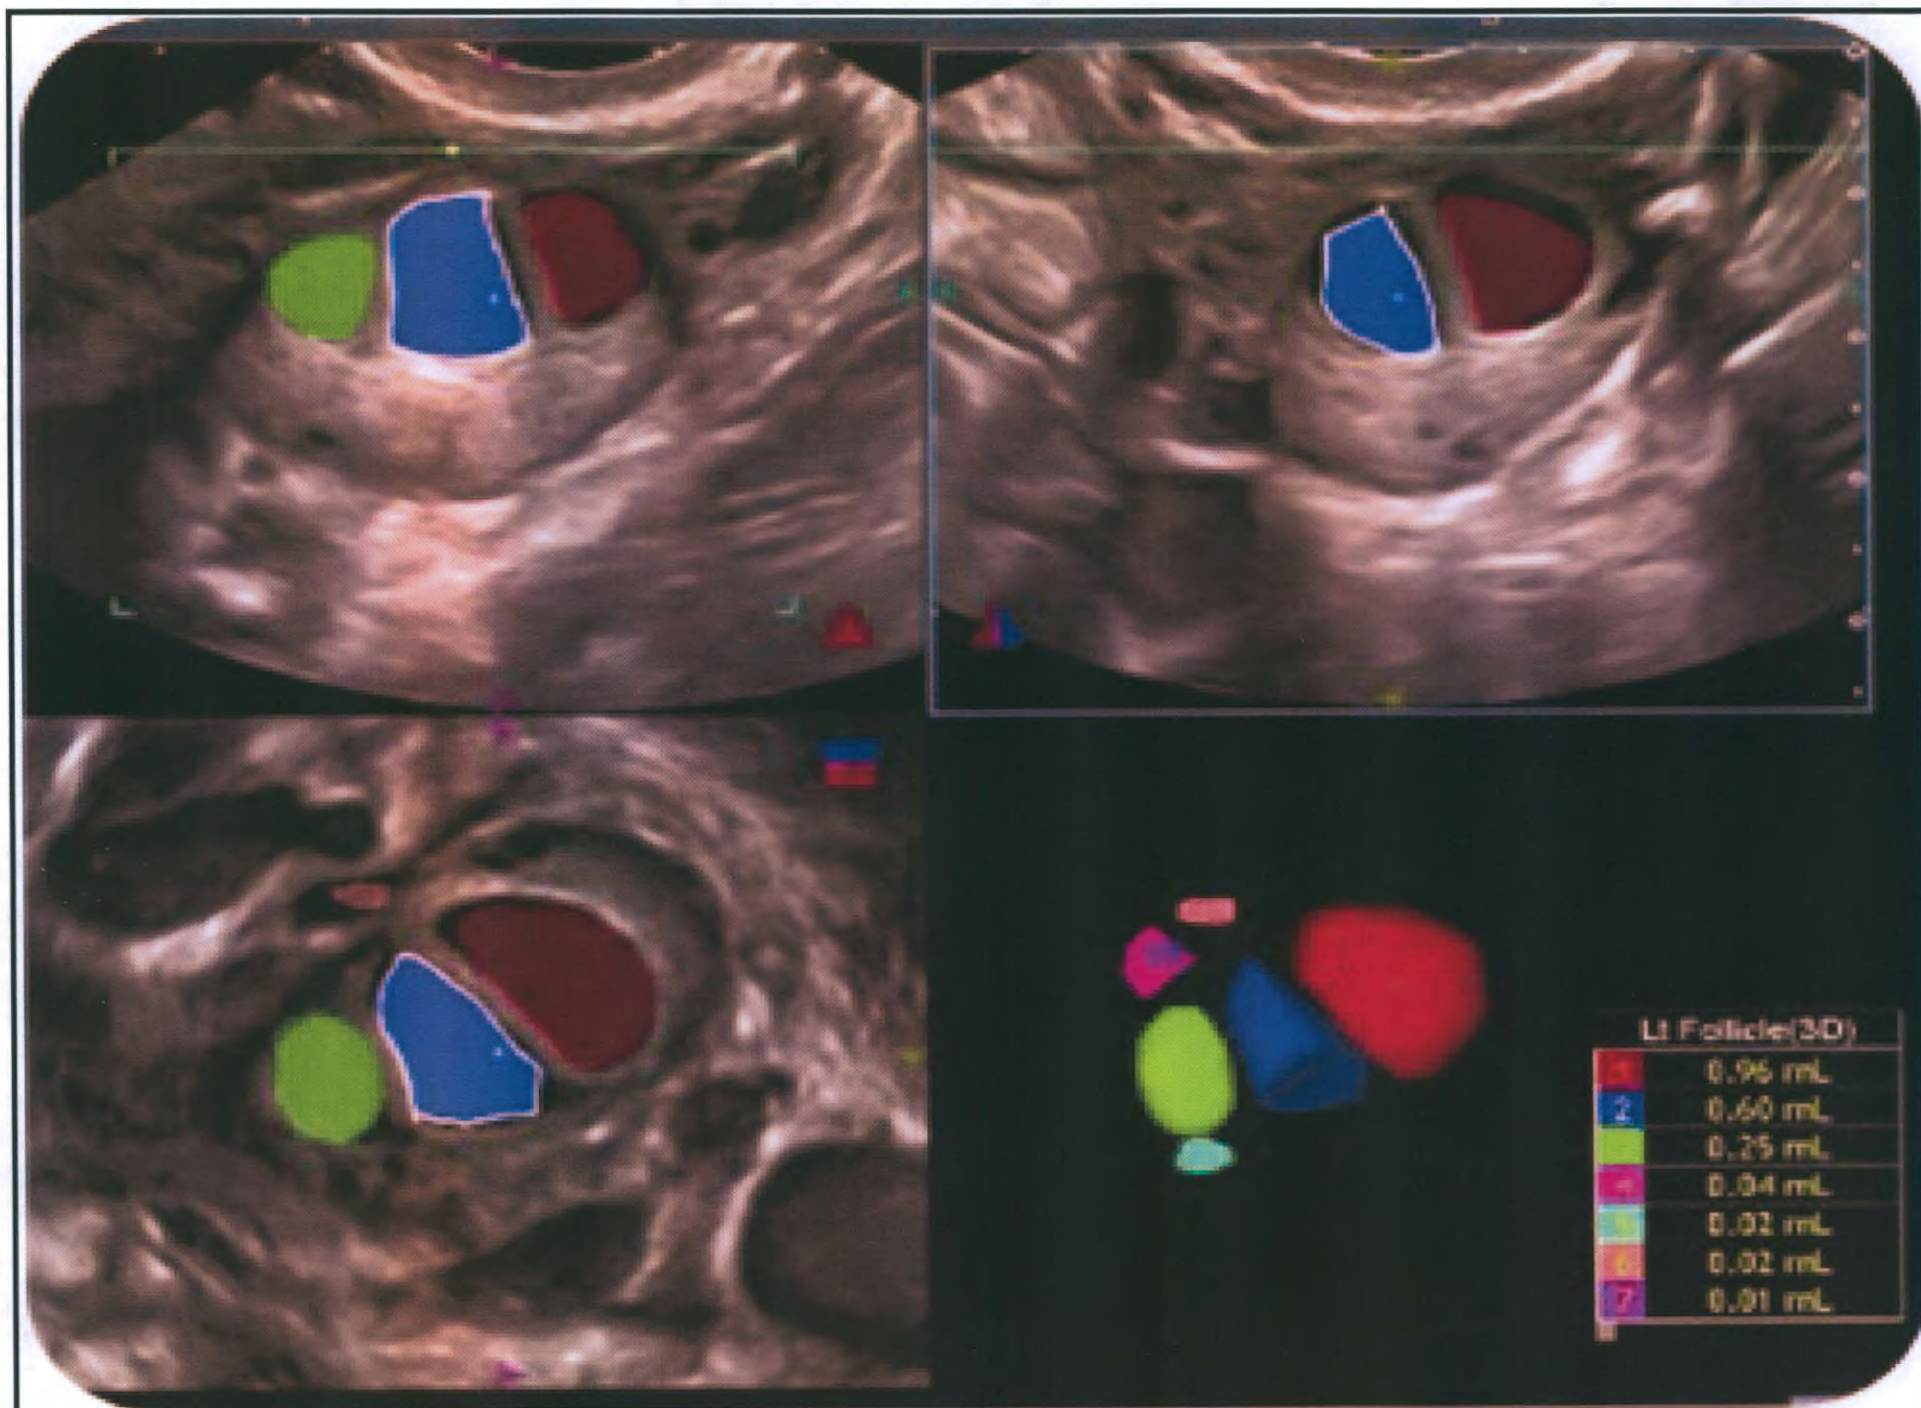



The screenshot displays the WinBox configuration utility. The left sidebar contains navigation options: Home, Config (selected), and Logs. Under Config, there are links for Site Description, System Management, Date & Time, Option Management, System ID, Option Settings, and Backup.


The main window shows the "License Management" section with a table listing installed licenses:

| License Code              | Status      | Expiration | Expiry Date | Description | Installation |
|---------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|--------------|
| 1HGF43HYQSKHPDOOCTREB     | Not Expired | 01.01.2018 | Service     | 08.05.2017  |              |
| 1A977JXMBV5U2Z7TMMNMQ94   | Not Expired | 06.05.2018 | US12-A1900A | 08.05.2017  |              |
| 1XQOOCLKEEPHQXRBRRCDEI    | Not Expired | 06.05.2018 | USMT-A1900A | 08.05.2017  |              |
| 1MVKRYBF64R07P2222222222  | Not Expired | 06.05.2018 | USMT-A1900A | 08.05.2017  |              |
| 1E00B3OTDZSDAY8222222222  | Not Expired | 06.05.2018 | USCQ-A1900A | 08.05.2017  |              |
| 1FCMHKXVUXLOJGAB87777XTTO | Not Expired | 06.05.2018 | USCQ-A1901A | 08.05.2017  |              |
| 1YXXVD02HCDDXJNM-HH-H7338 | Not Expired | 06.05.2018 | USLM-A1900A | 08.05.2017  |              |
| 1KJHH6DWL3ON2ZXRLLLLB774  | Not Expired | 06.05.2018 | USFT-A1900A | 08.05.2017  |              |
| 1GPDQNQ7H4DFNKVLFFF5118   | Not Expired | 06.05.2018 | USPA-A1900A | 08.05.2017  |              |
| 1GFDQM7NDAP74P34444MIIG   | Not Expired | 06.05.2018 | USTW-A1900A | 08.05.2017  |              |
| 121ZTHLMTMFDCXMPKMUHDOB   | Not Expired | 06.05.2018 | USSW-A1900A | 08.05.2017  |              |
| 1ONLLGUFBMLJGT7IOCCOCZYFA | Not Expired | 06.05.2018 | USMP-A1900A | 08.05.2017  |              |
| 1TSQQH4FNGKJC9VGAMAAABAS  | Not Expired | 06.05.2018 | USEL-A1901A | 08.05.2017  |              |
| 1HGEEAVG974MDIVTPPPFPBB8  | Not Expired | 06.05.2018 | USSW-A1900A | 08.05.2017  |              |
| 1SRPPSACJBMYVS7022222222  | Not Expired | 06.05.2018 | USPV-A1900A | 08.05.2017  |              |

Below the table are buttons for "Details >>>", "Select All", "Add...", "Edit", and "Remove...". At the bottom of the interface are buttons for "Add Favorite", "Previous", "Next", and "QUIT". A timestamp "29.11.2017 17:01:10" is visible in the bottom right corner.




## 19. Программное приложение для эластографии

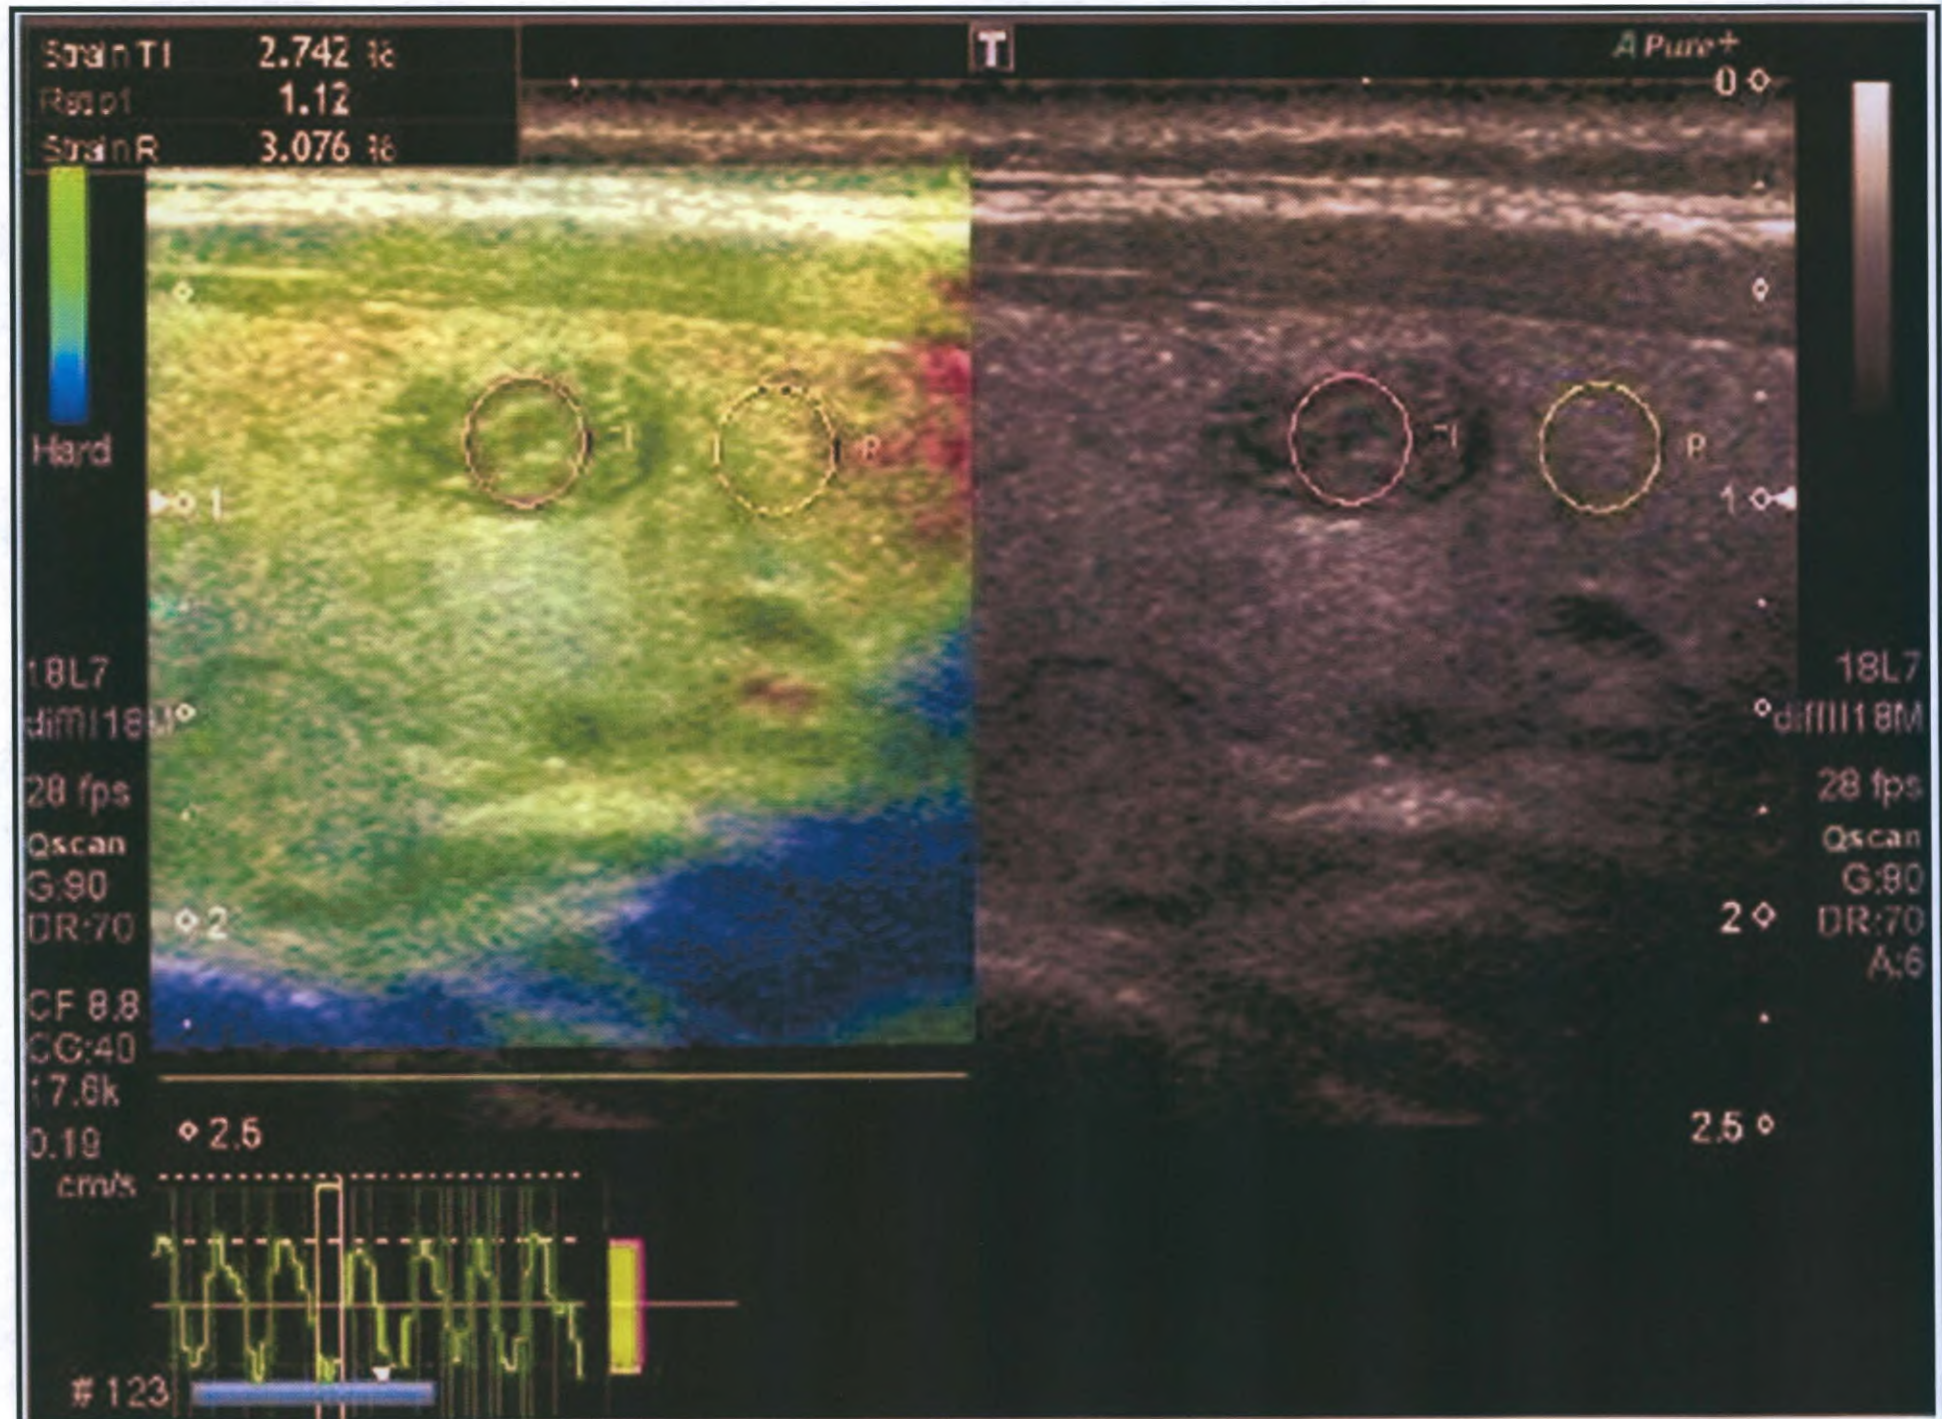



8. Держатель для датчика транспищеводного мультипланового

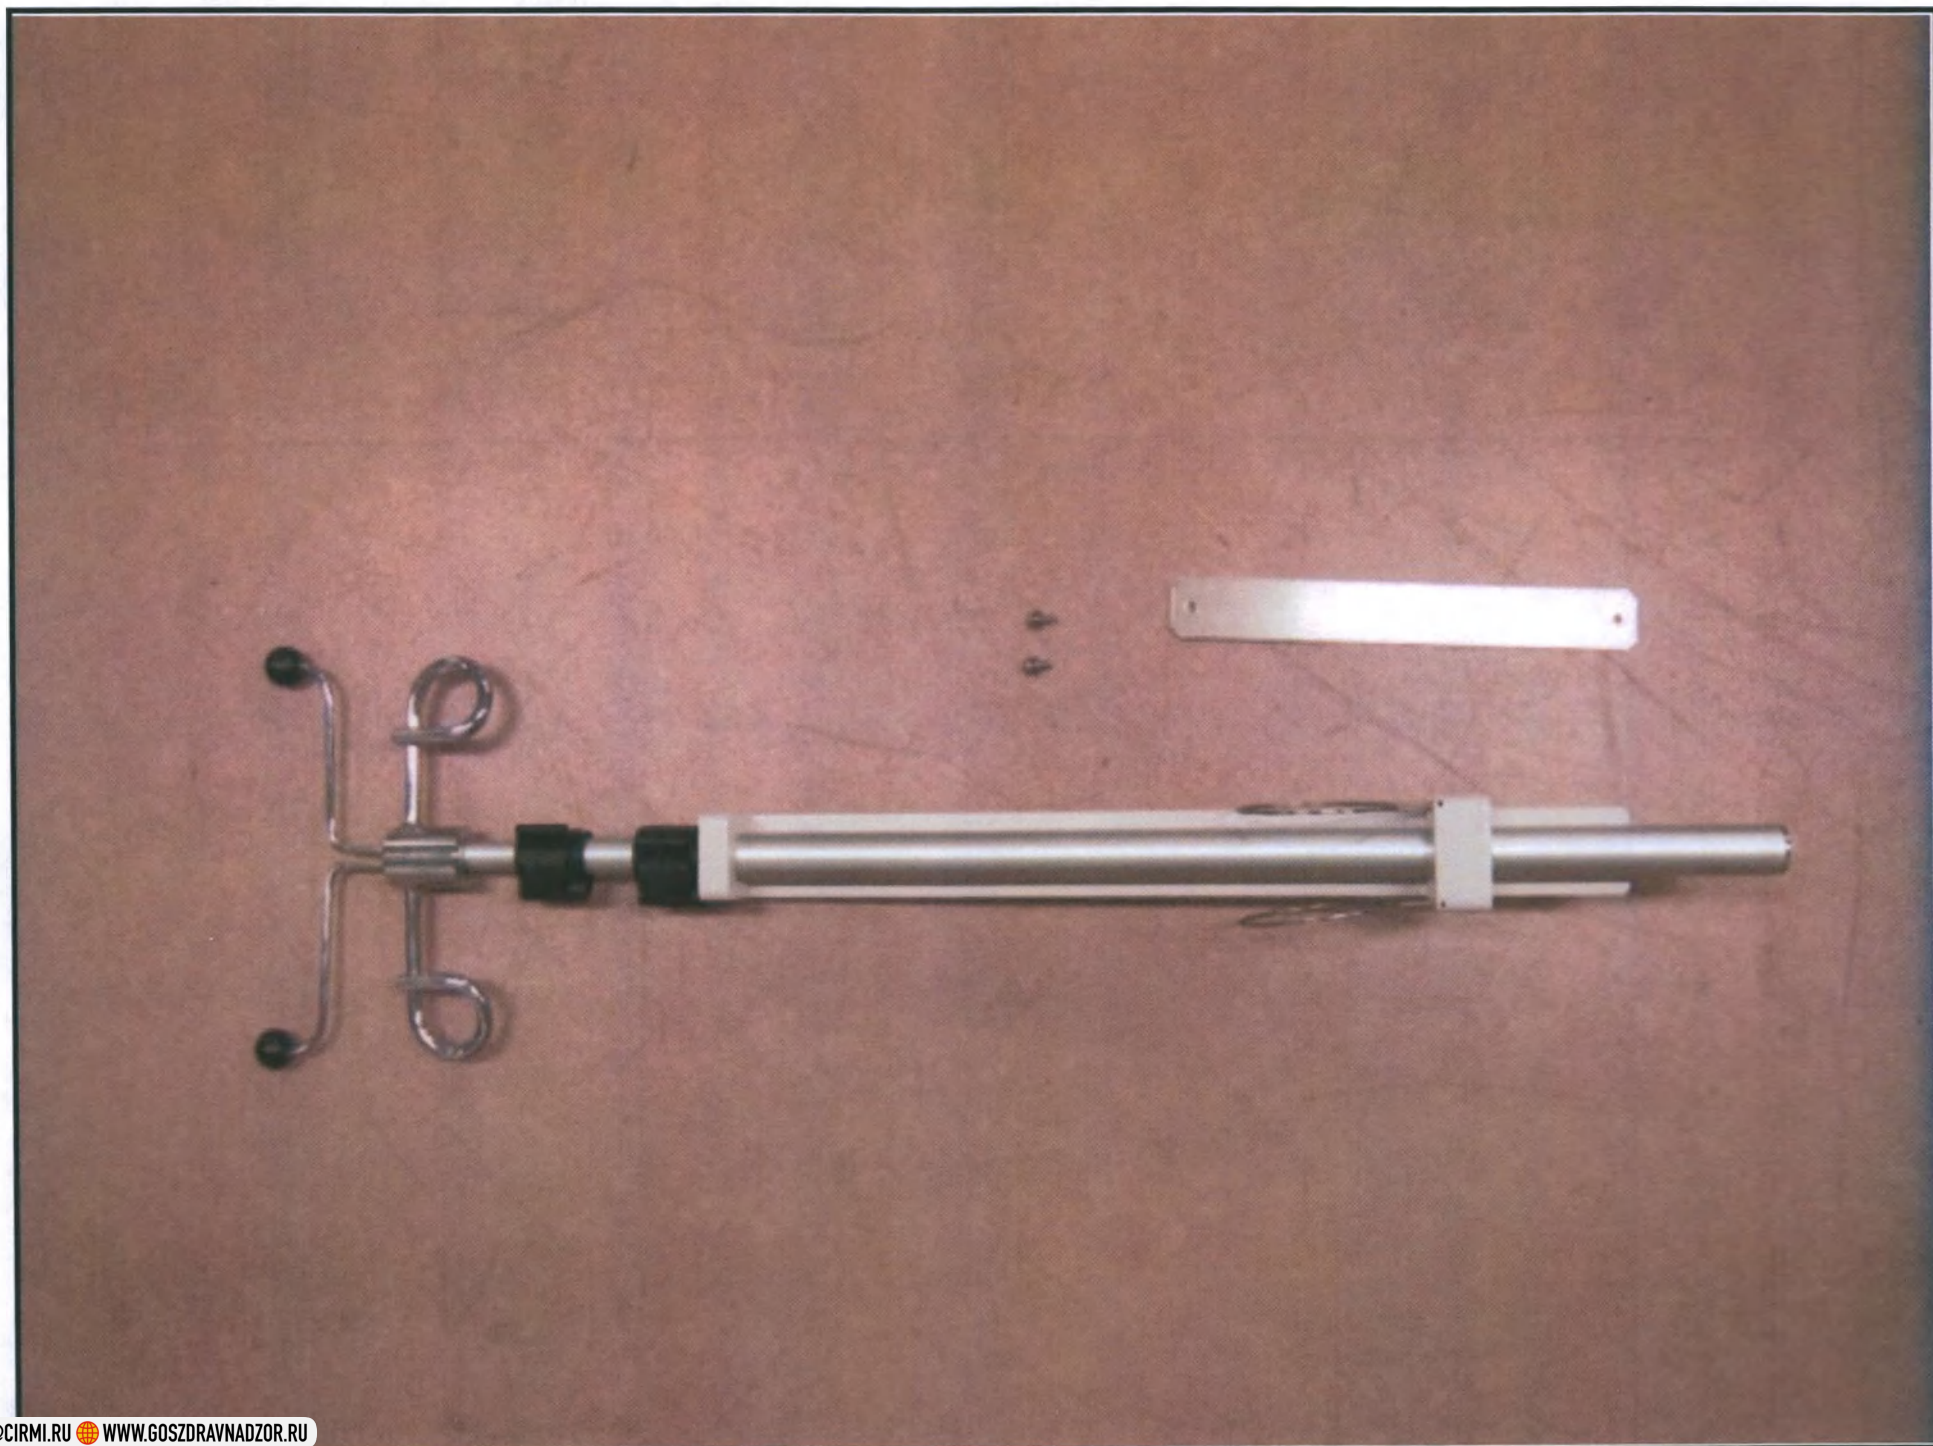



9. Модуль специализированный кардио-сосудистый (CV)

**Наклейка на блок  
системы - 2 шт.**



**Наклейка на  
монитор - 1 шт.**






10. Модуль регулятора STC на панели управления






11. Программное приложение для исследования с контрастами (СНП)

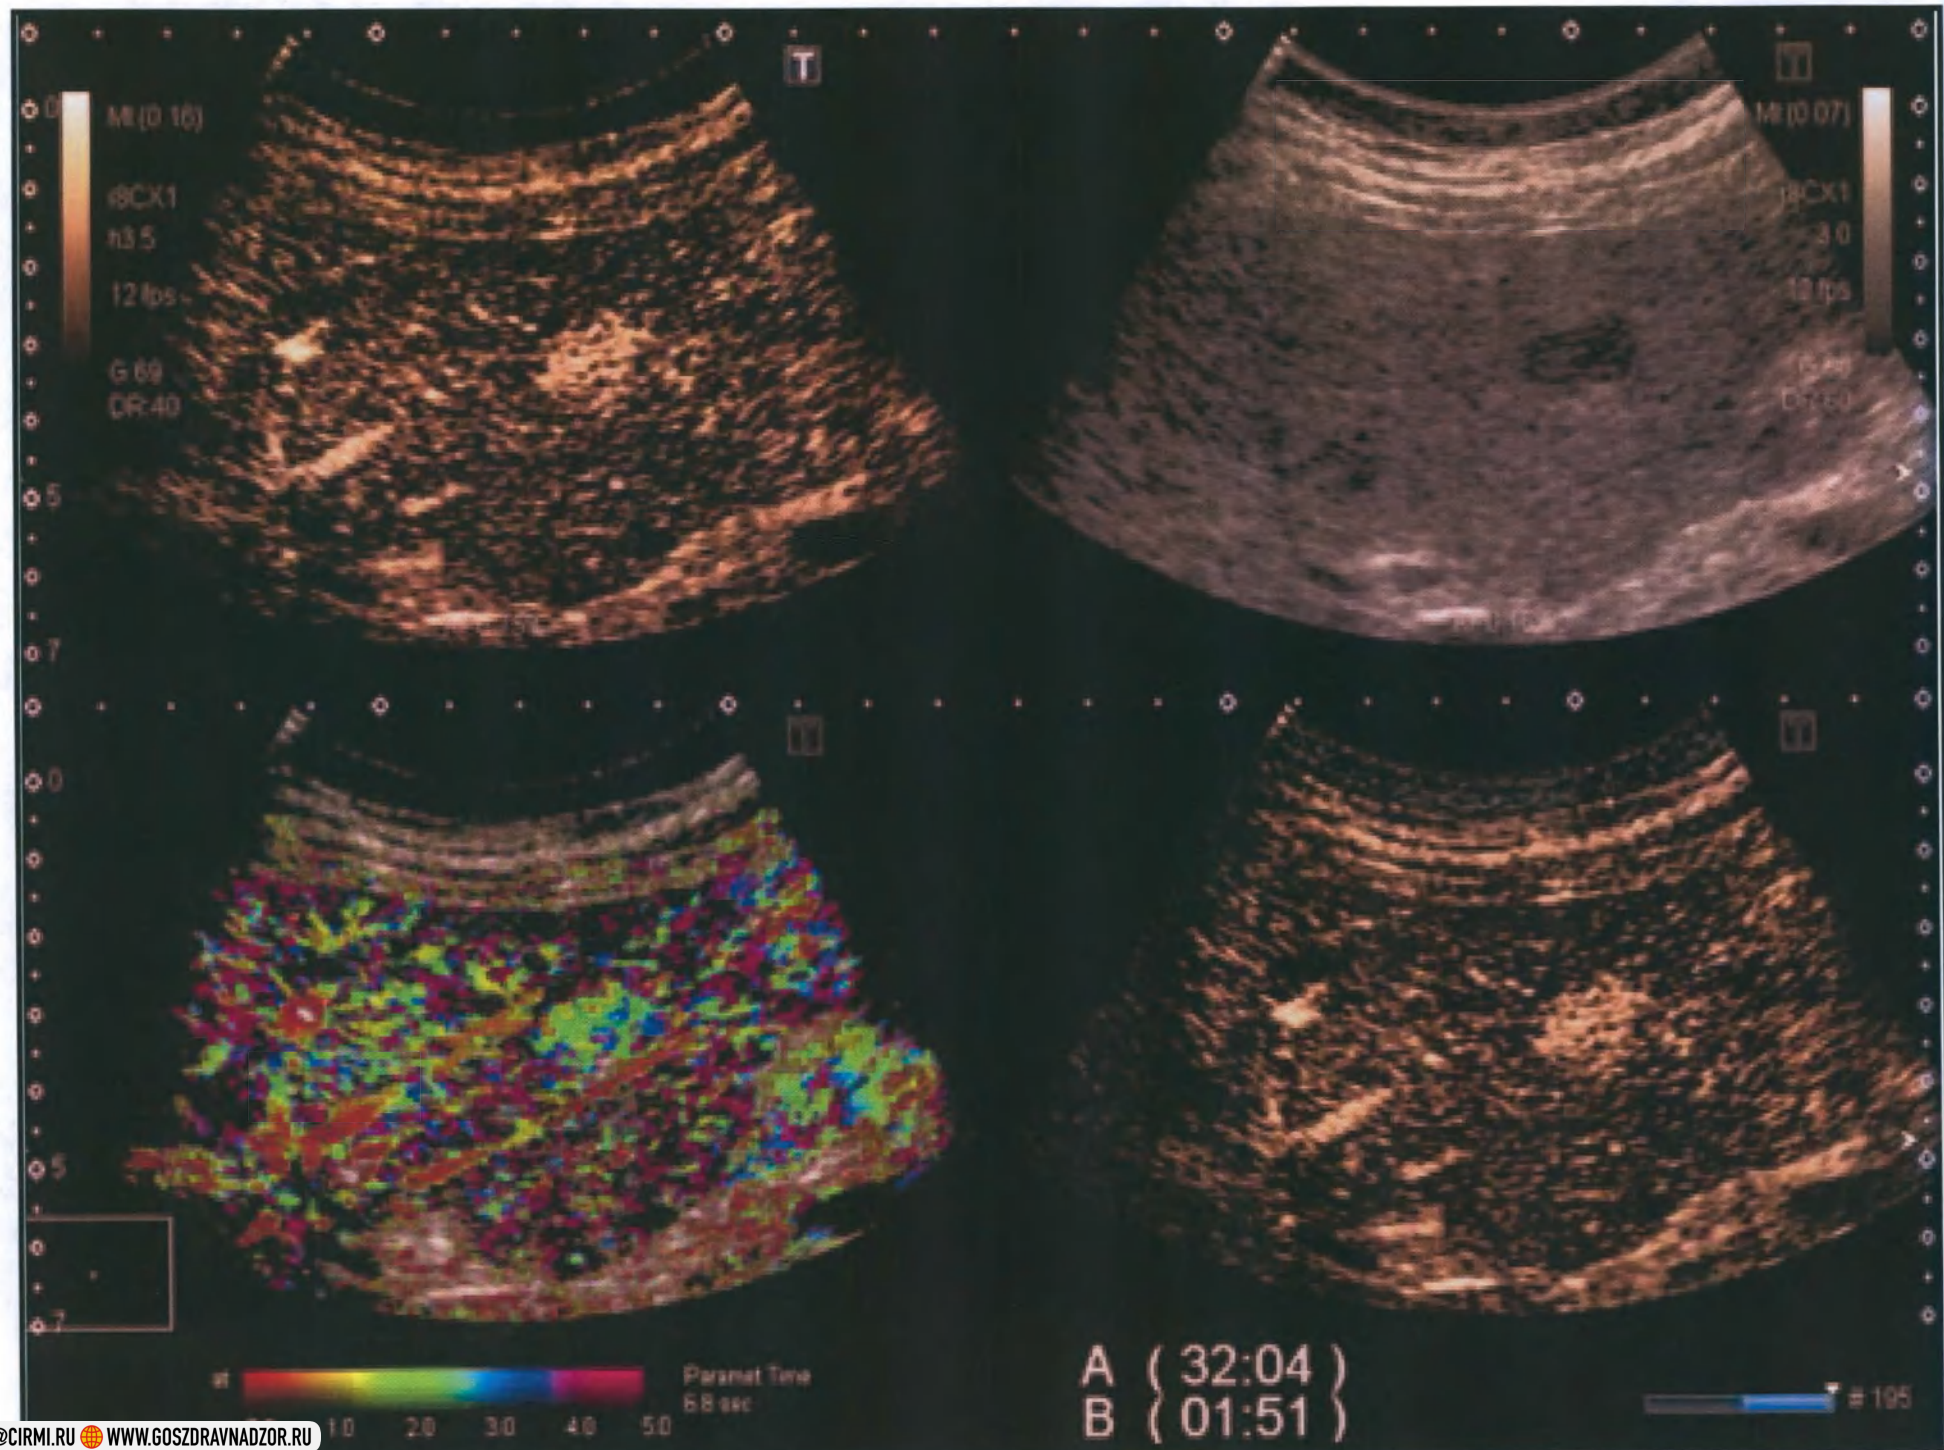




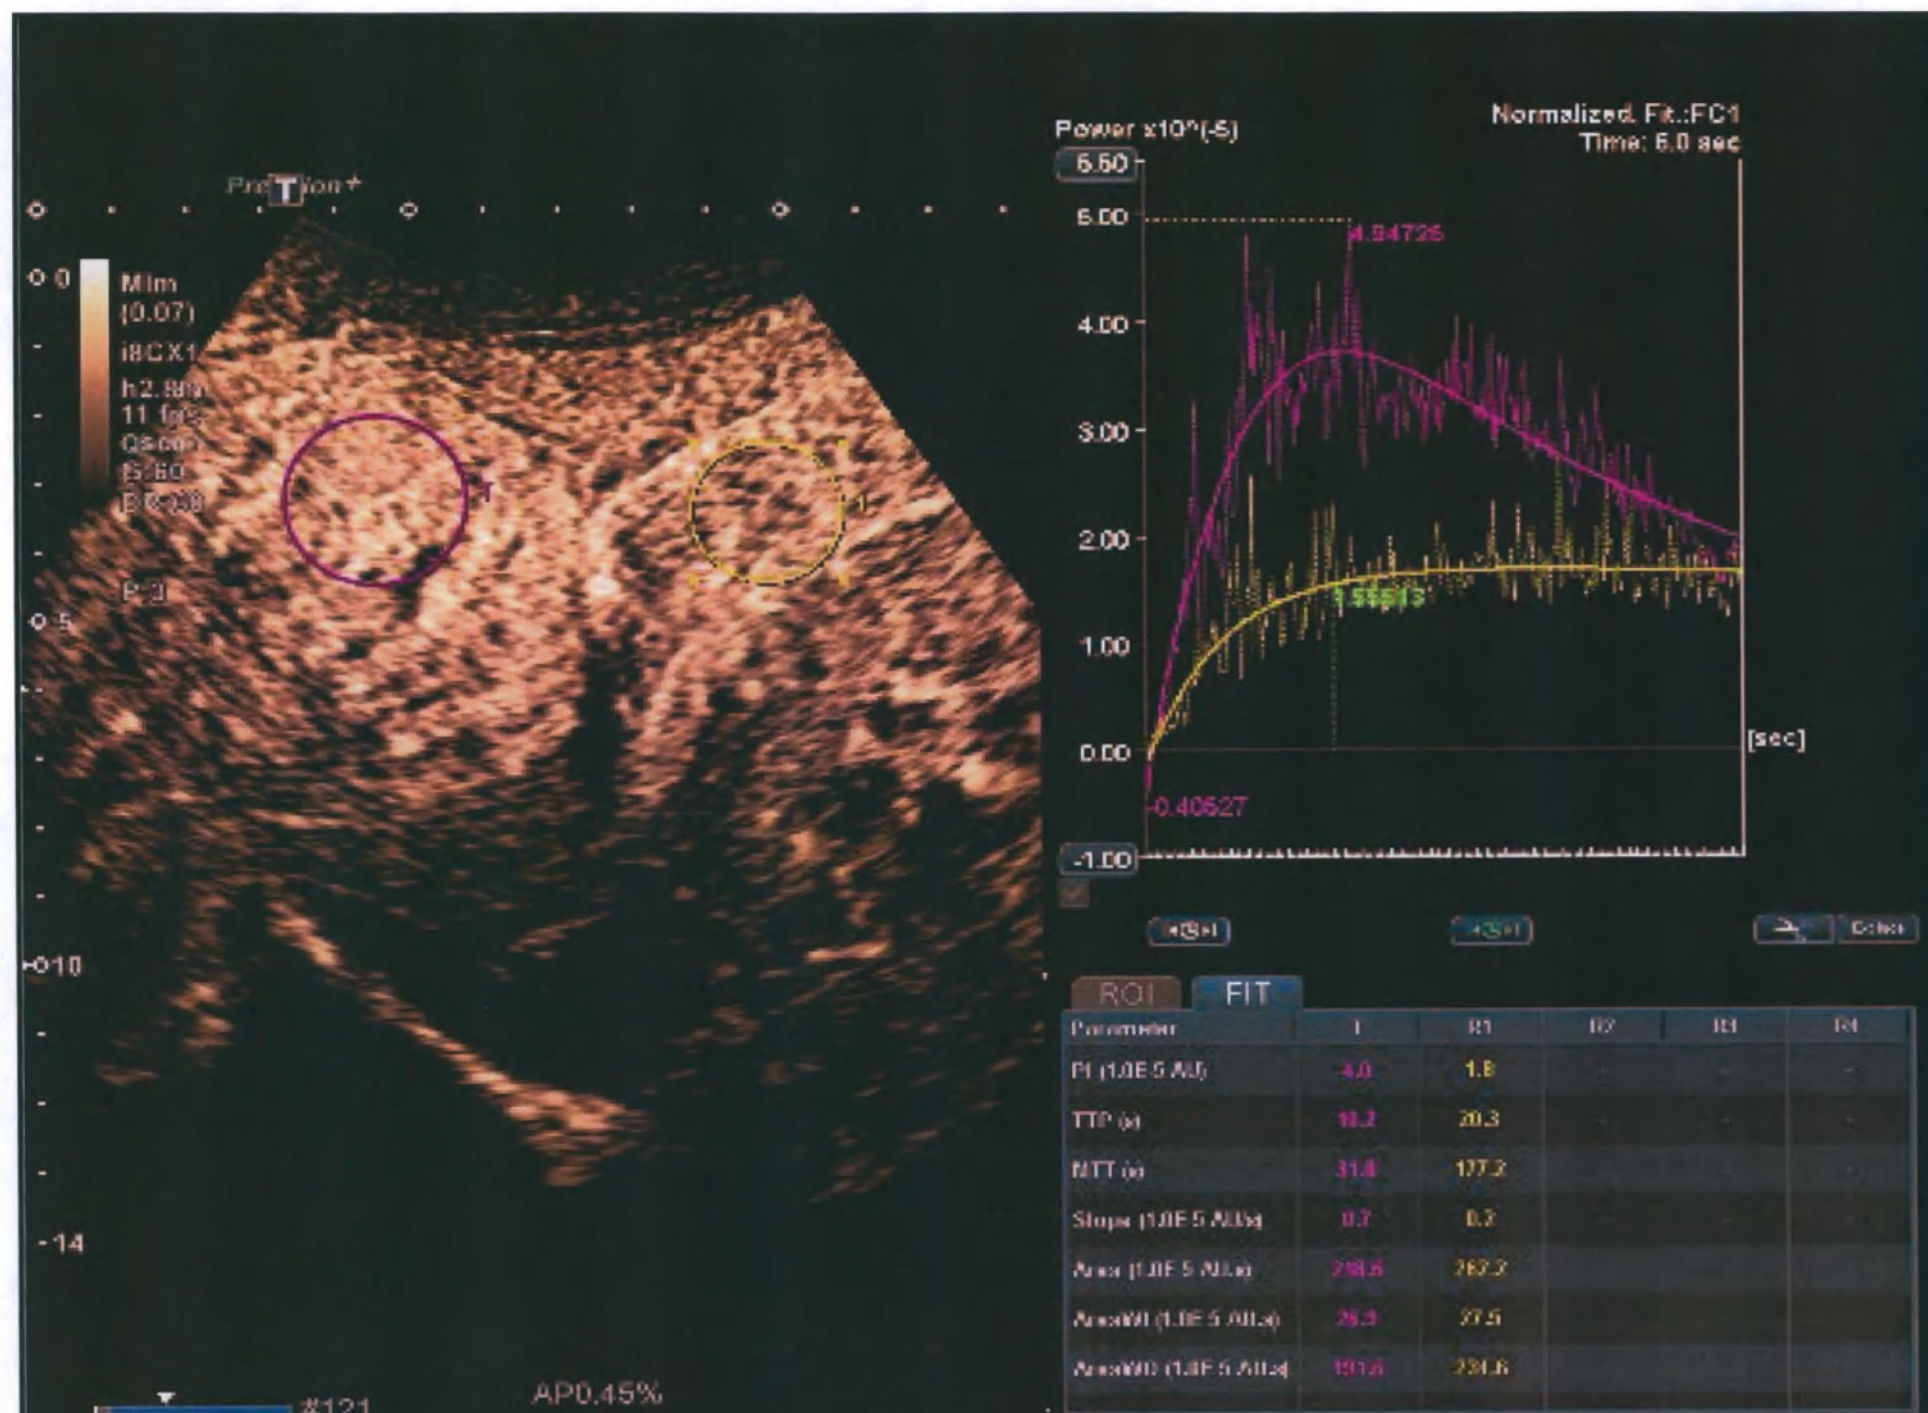




13. Программное приложение для аппроксимации кривой (Fitting Curve) (только для варианта исполнения Aplio a550(модель CUS-AA550))

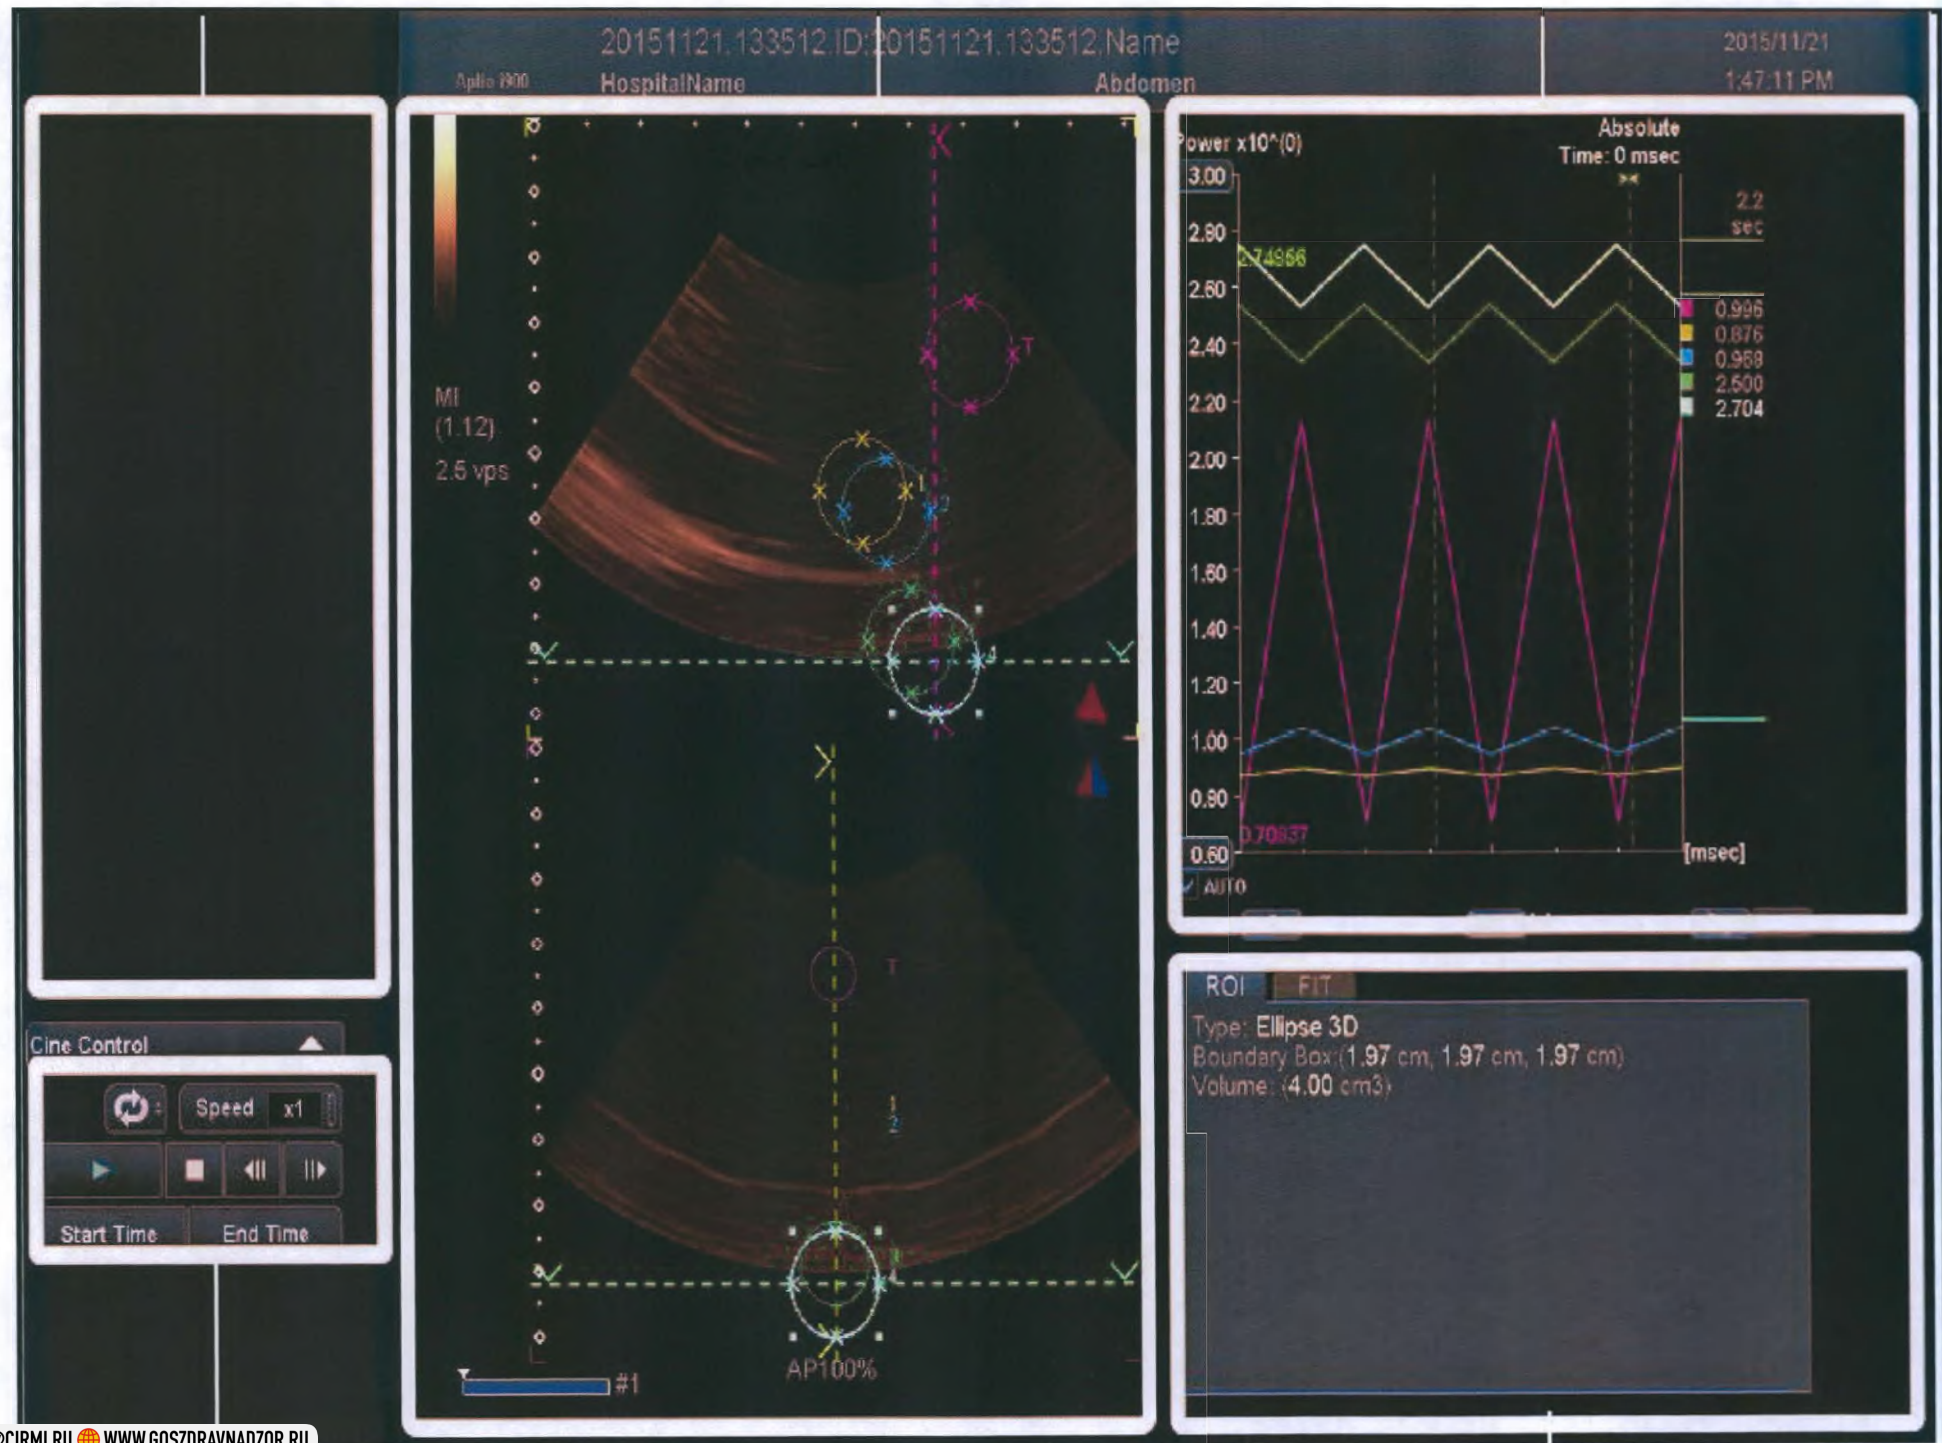



## 14. Программное приложение для функции 4D

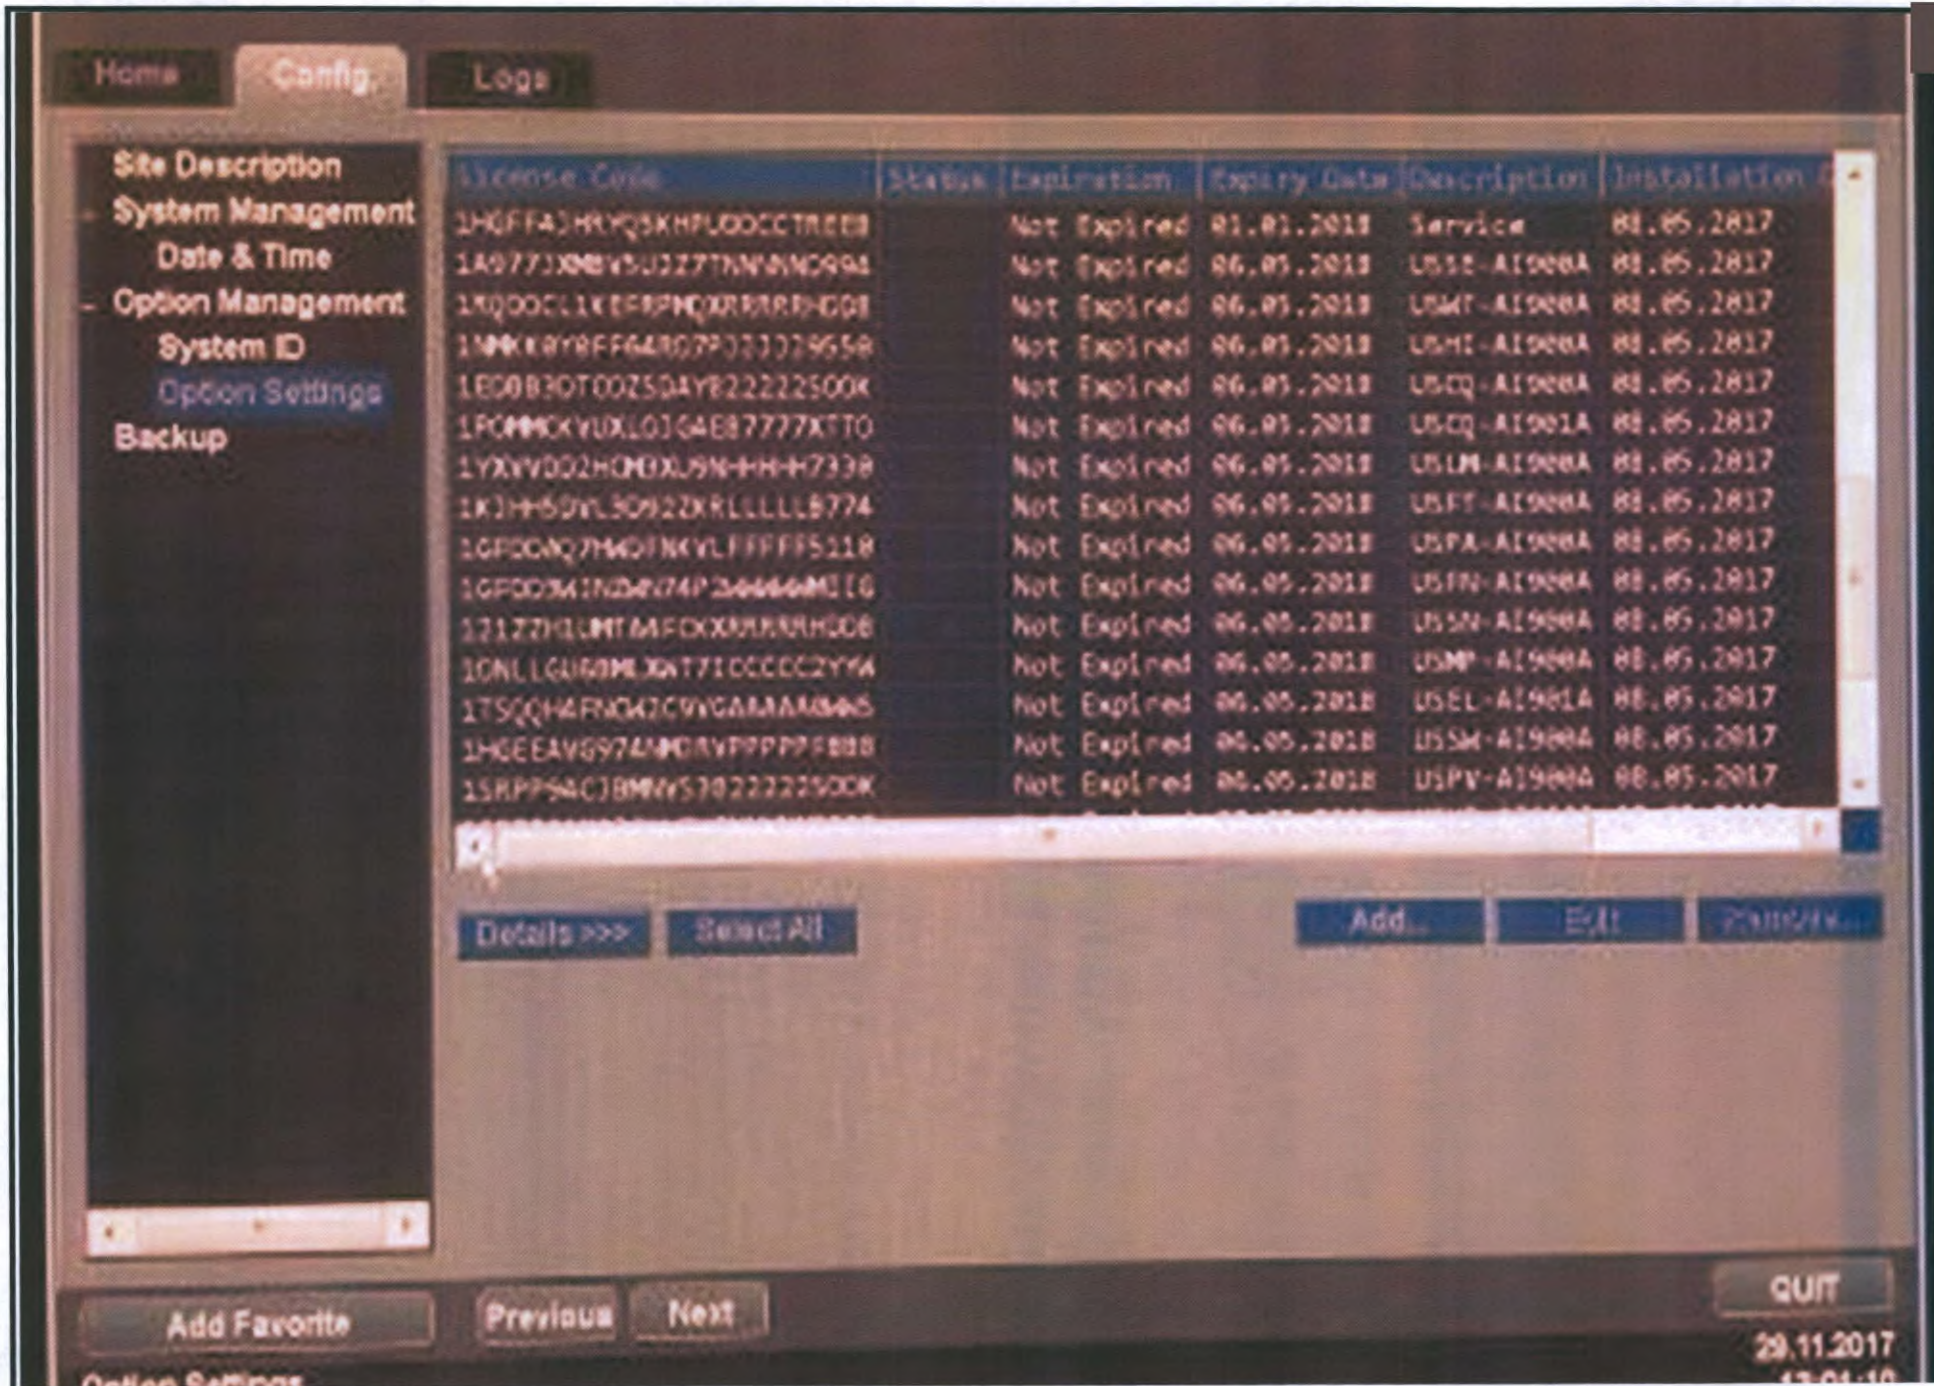



15. Программное приложение для виртуального освещения (Luminance)






16. Программное приложение для виртуального затенения (Shadow Glass) (только для варианта исполнения Aplio a550(модель CUS-AA550))






20. Программное приложение для эластографии сдвиговой волной (Shear wave)

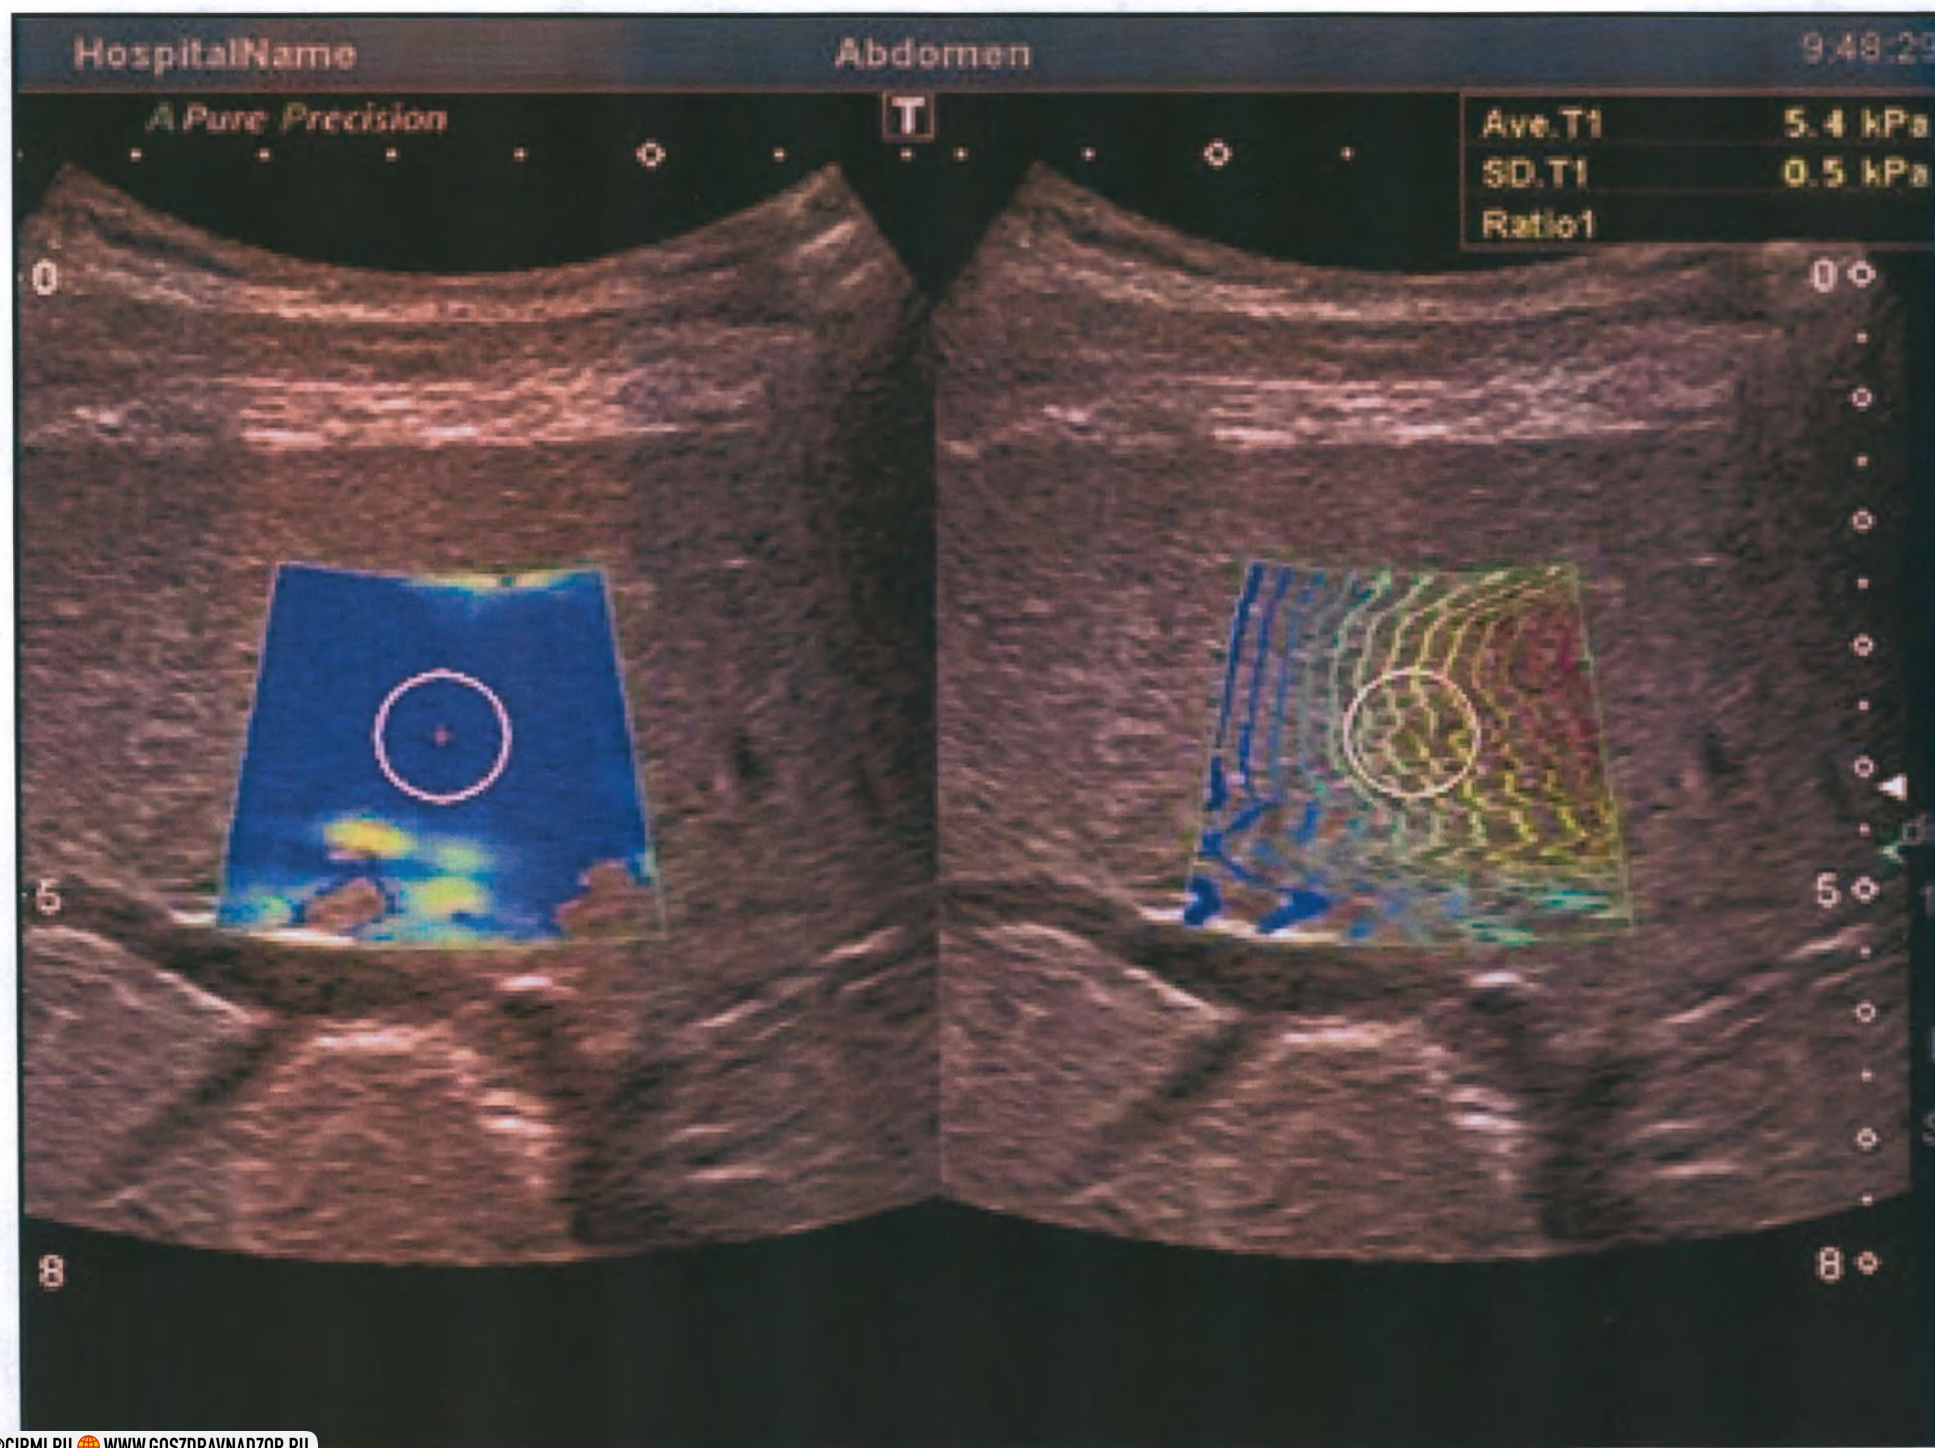




## 21. Программное приложение для функции Smart Fusion

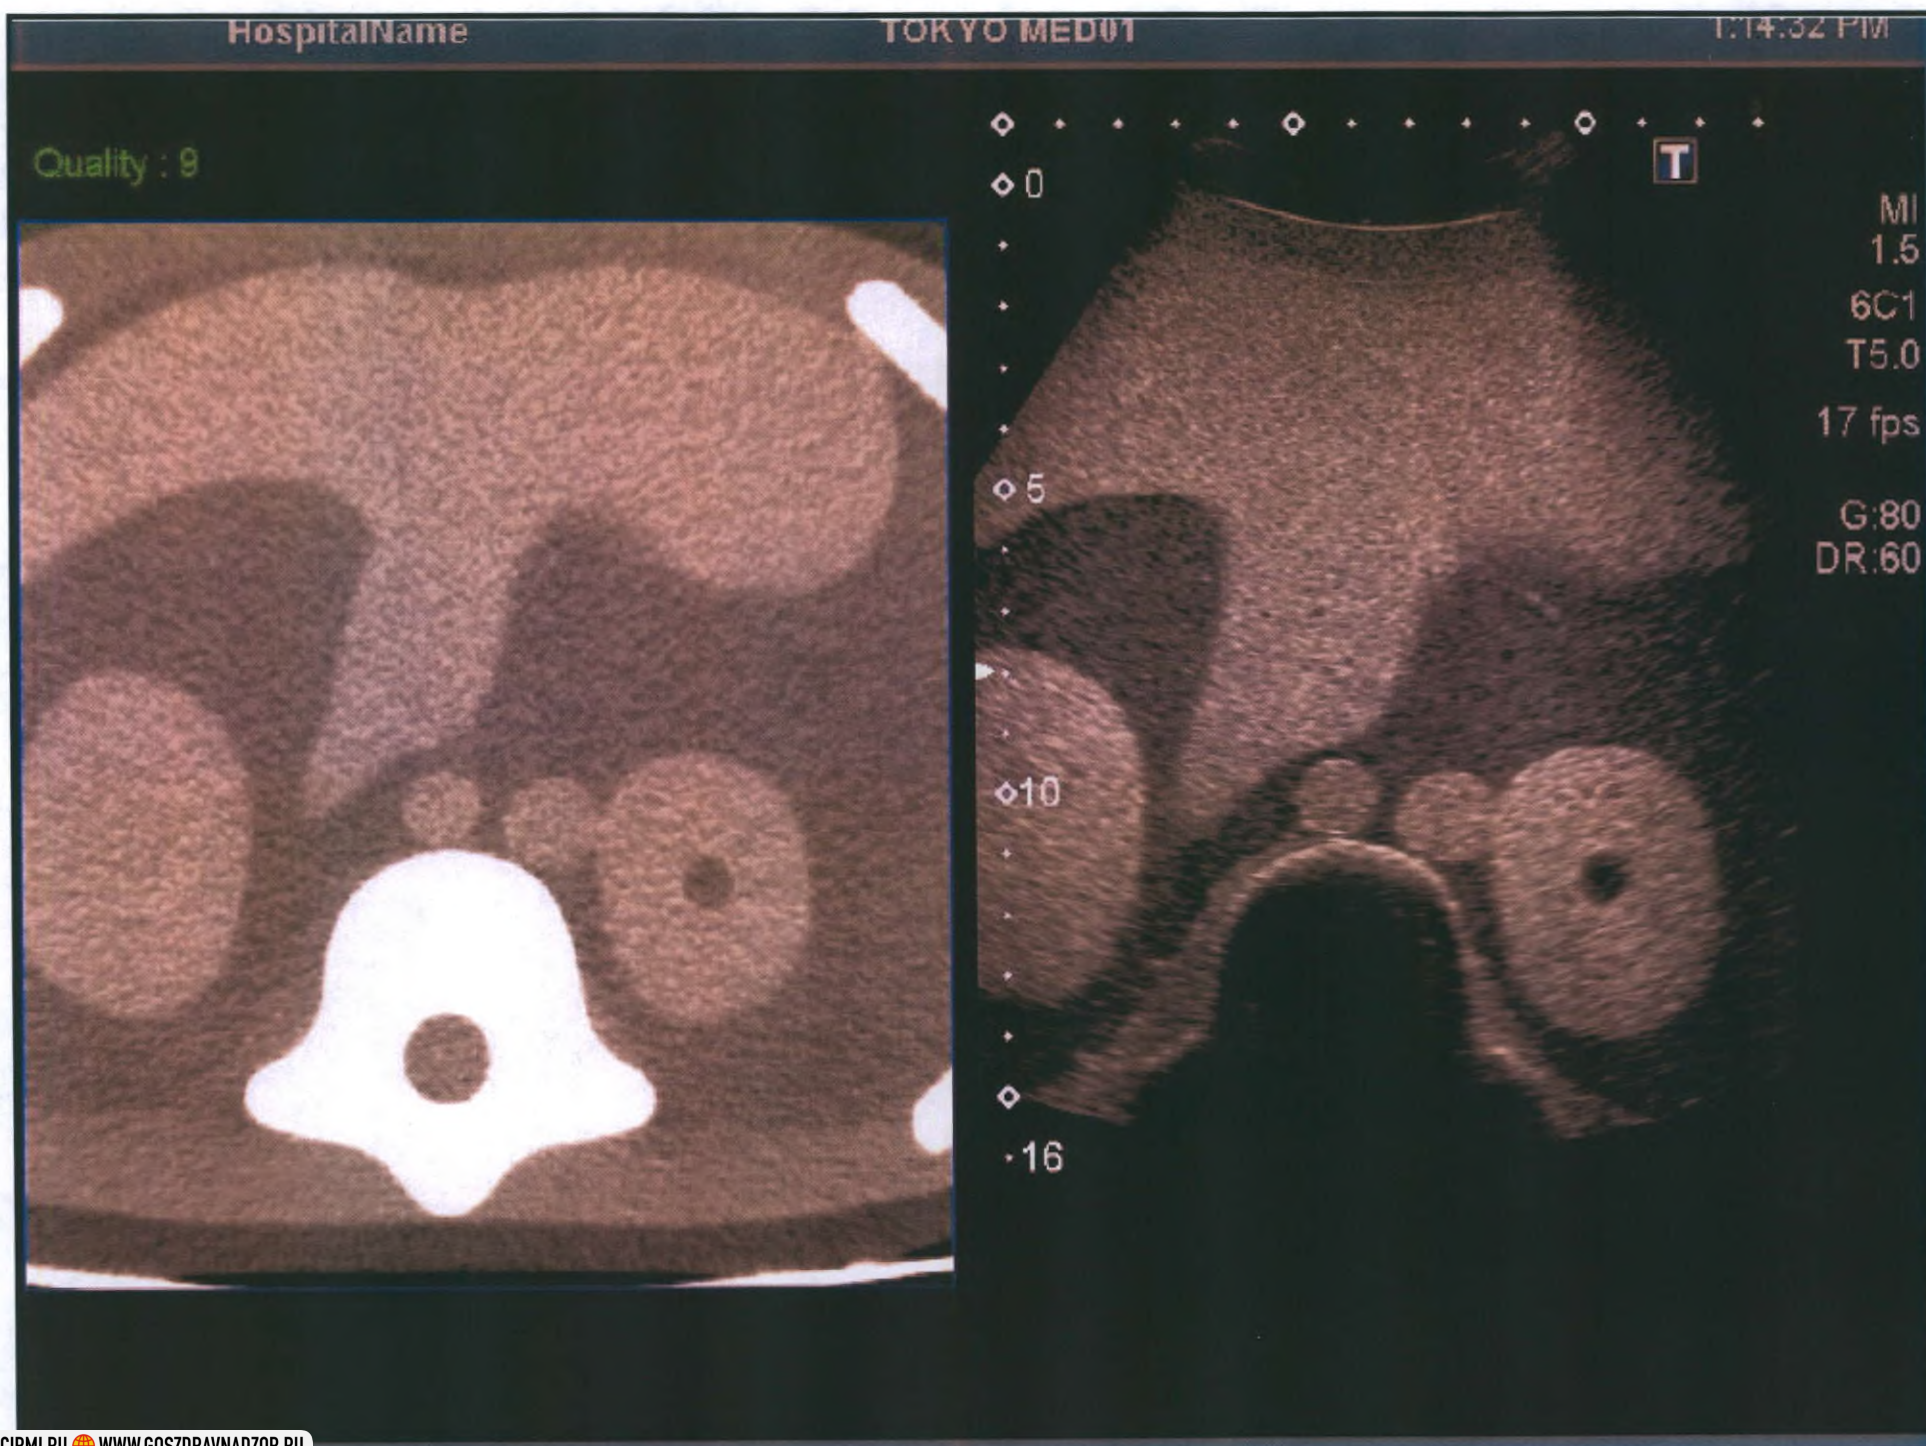



22. Программное приложение для функции Smart Navigation (применимо только для Модель CUS-AA550)

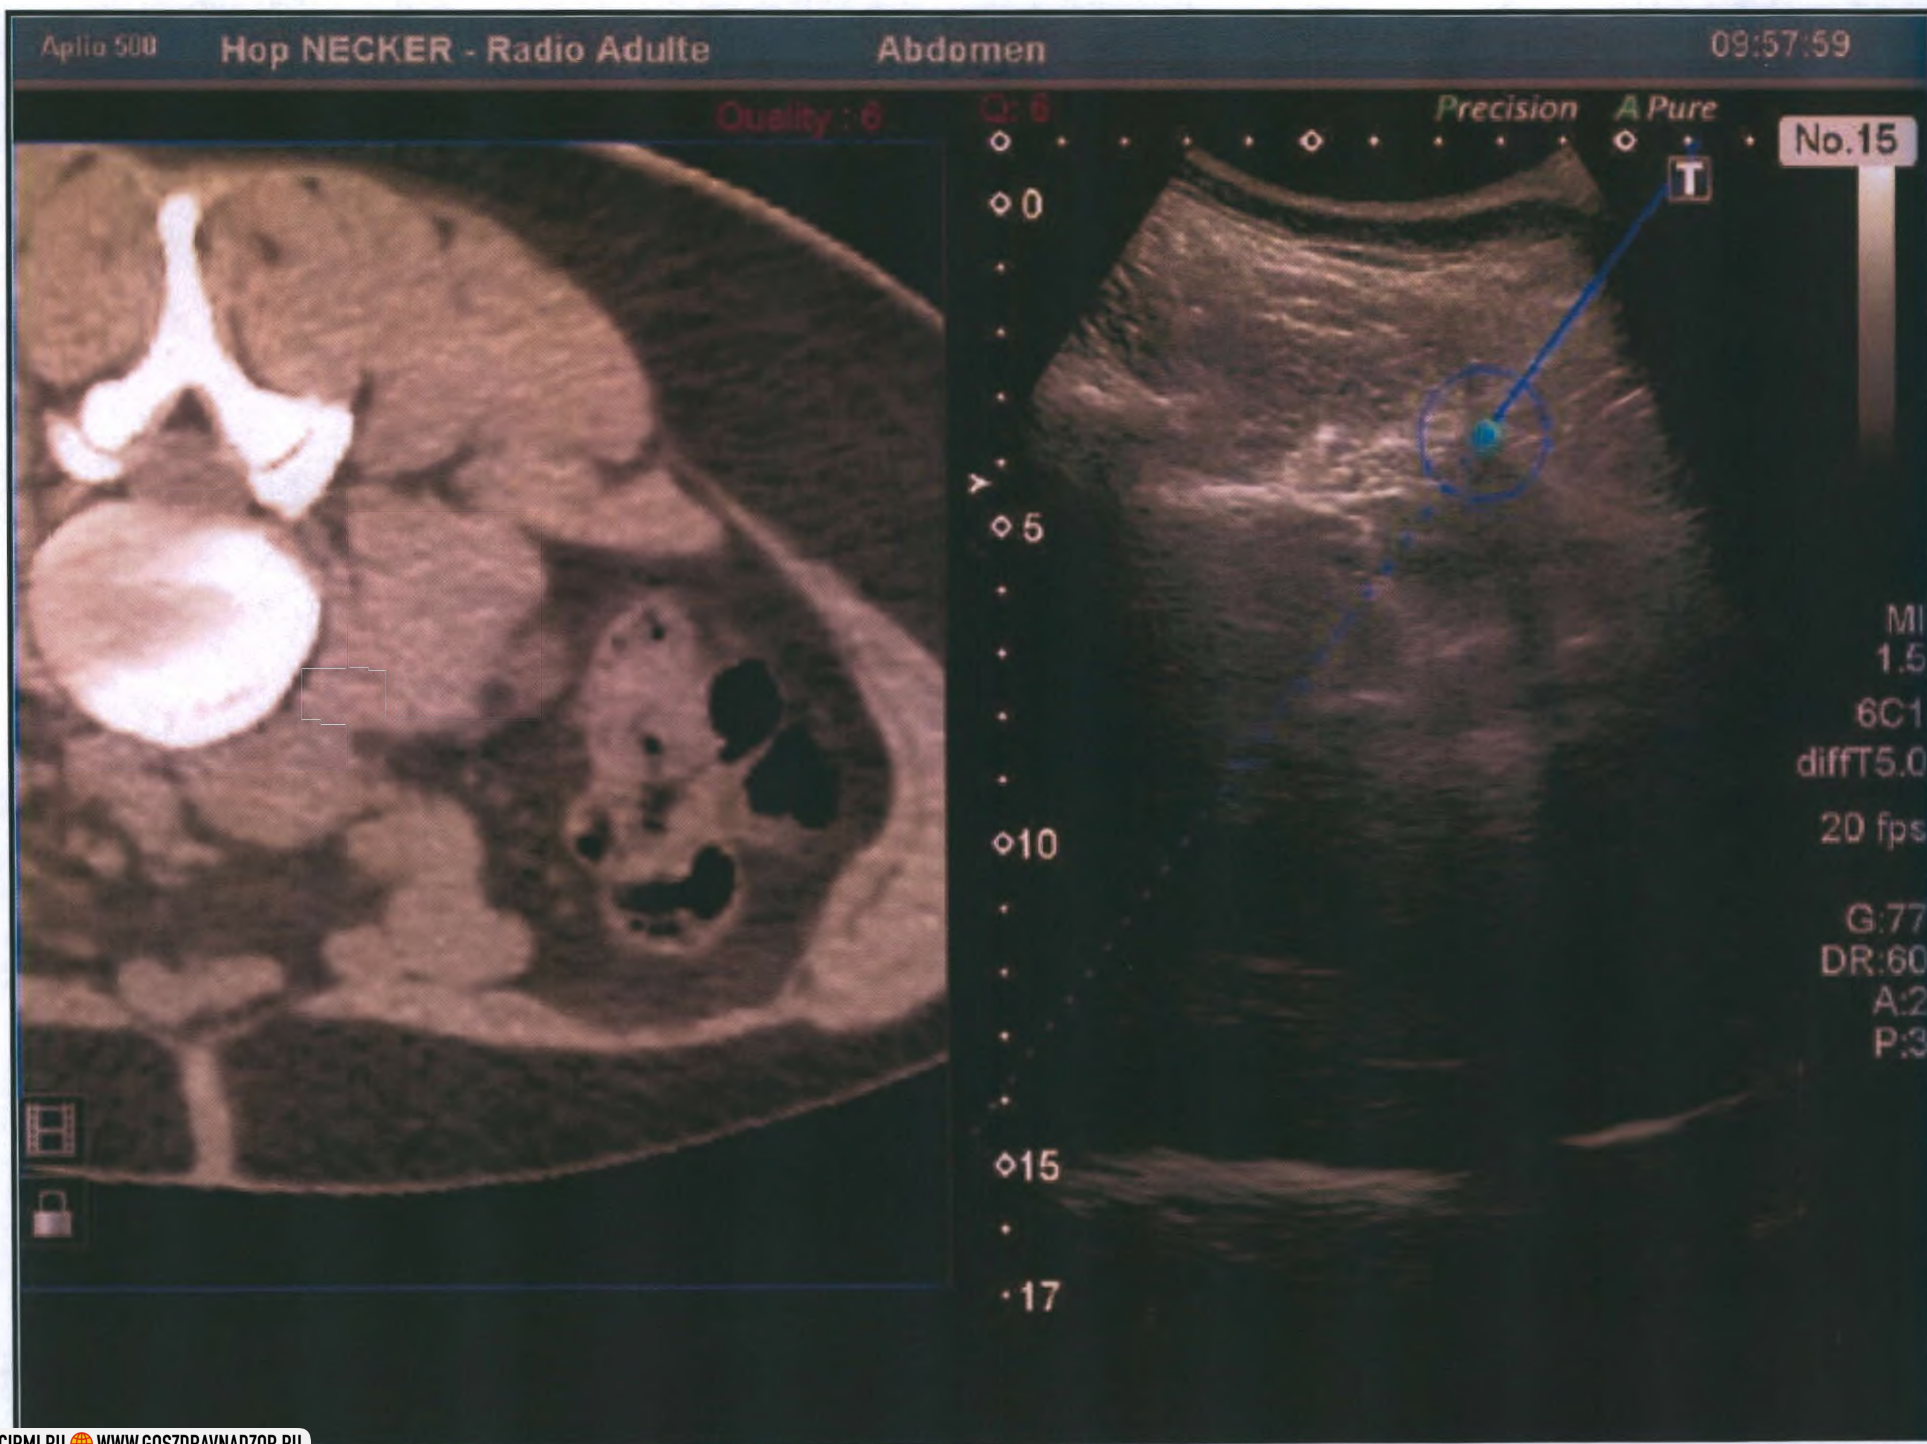




23. Набор для формирования поля в режиме мультимодальной визуализации





23. Набор для формирования поля в режиме мультимодальной визуализации

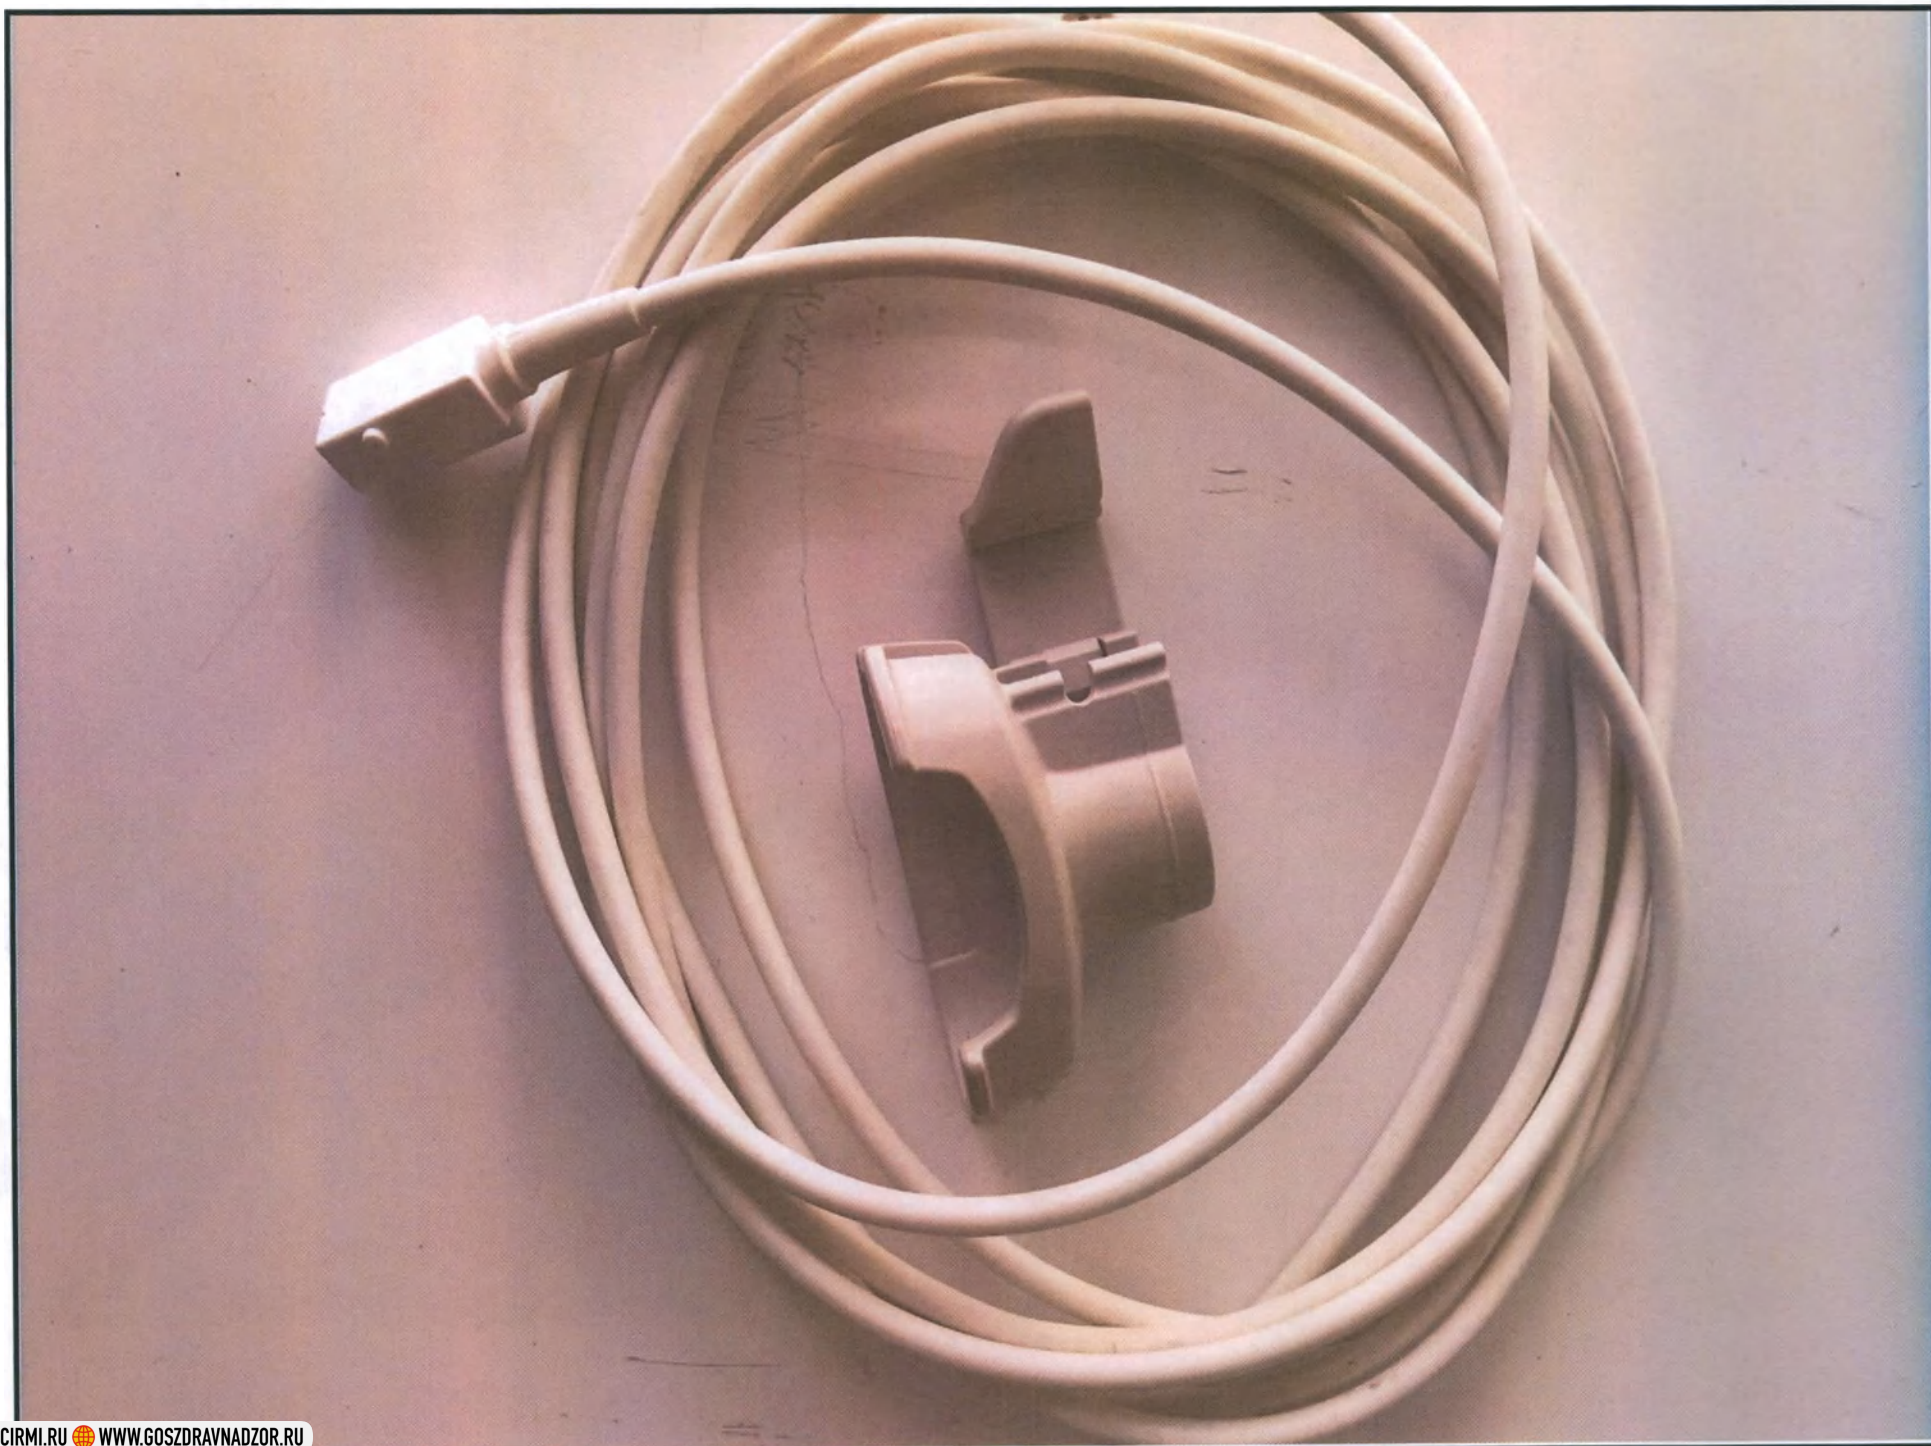



23. Набор для формирования поля в режиме мультимодальной визуализации





23. Набор для формирования поля в режиме мультимодальной визуализации






## 24. Сенсор для работы с несколькими датчиками





25. Программное приложение для автоматического совмещения данных для функции Smart Fusion

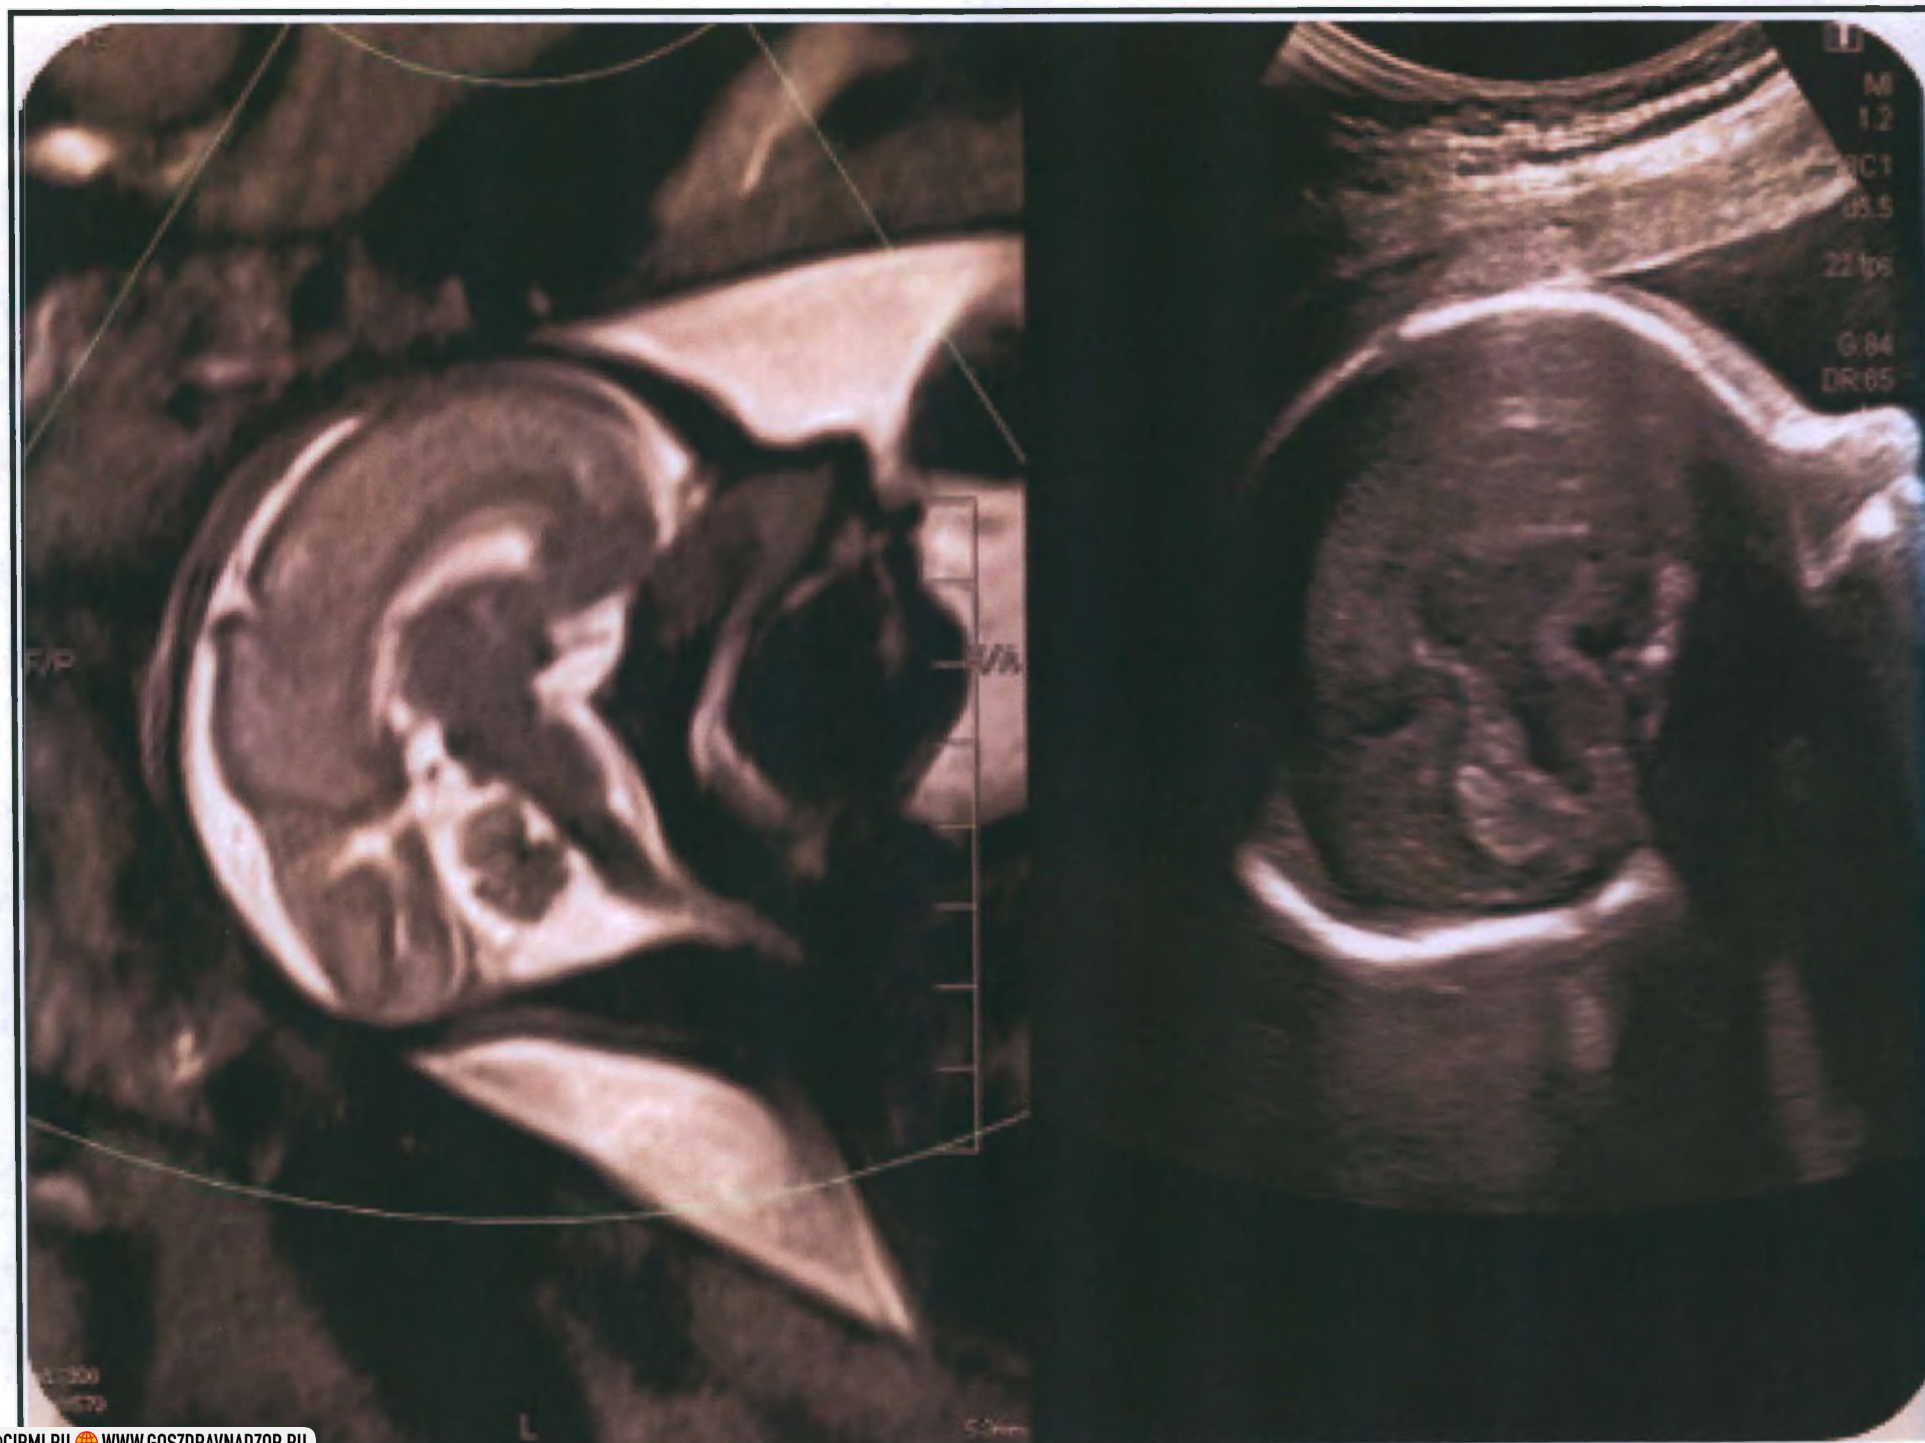



26. Стойка-тележка для позиционирования передающего устройства в режиме мультимодальной визуализации






27. Адаптер для позиционирования сенсора, модель UAFS-001A





27. Адаптер для позиционирования сенсора, модель UAFS-001A

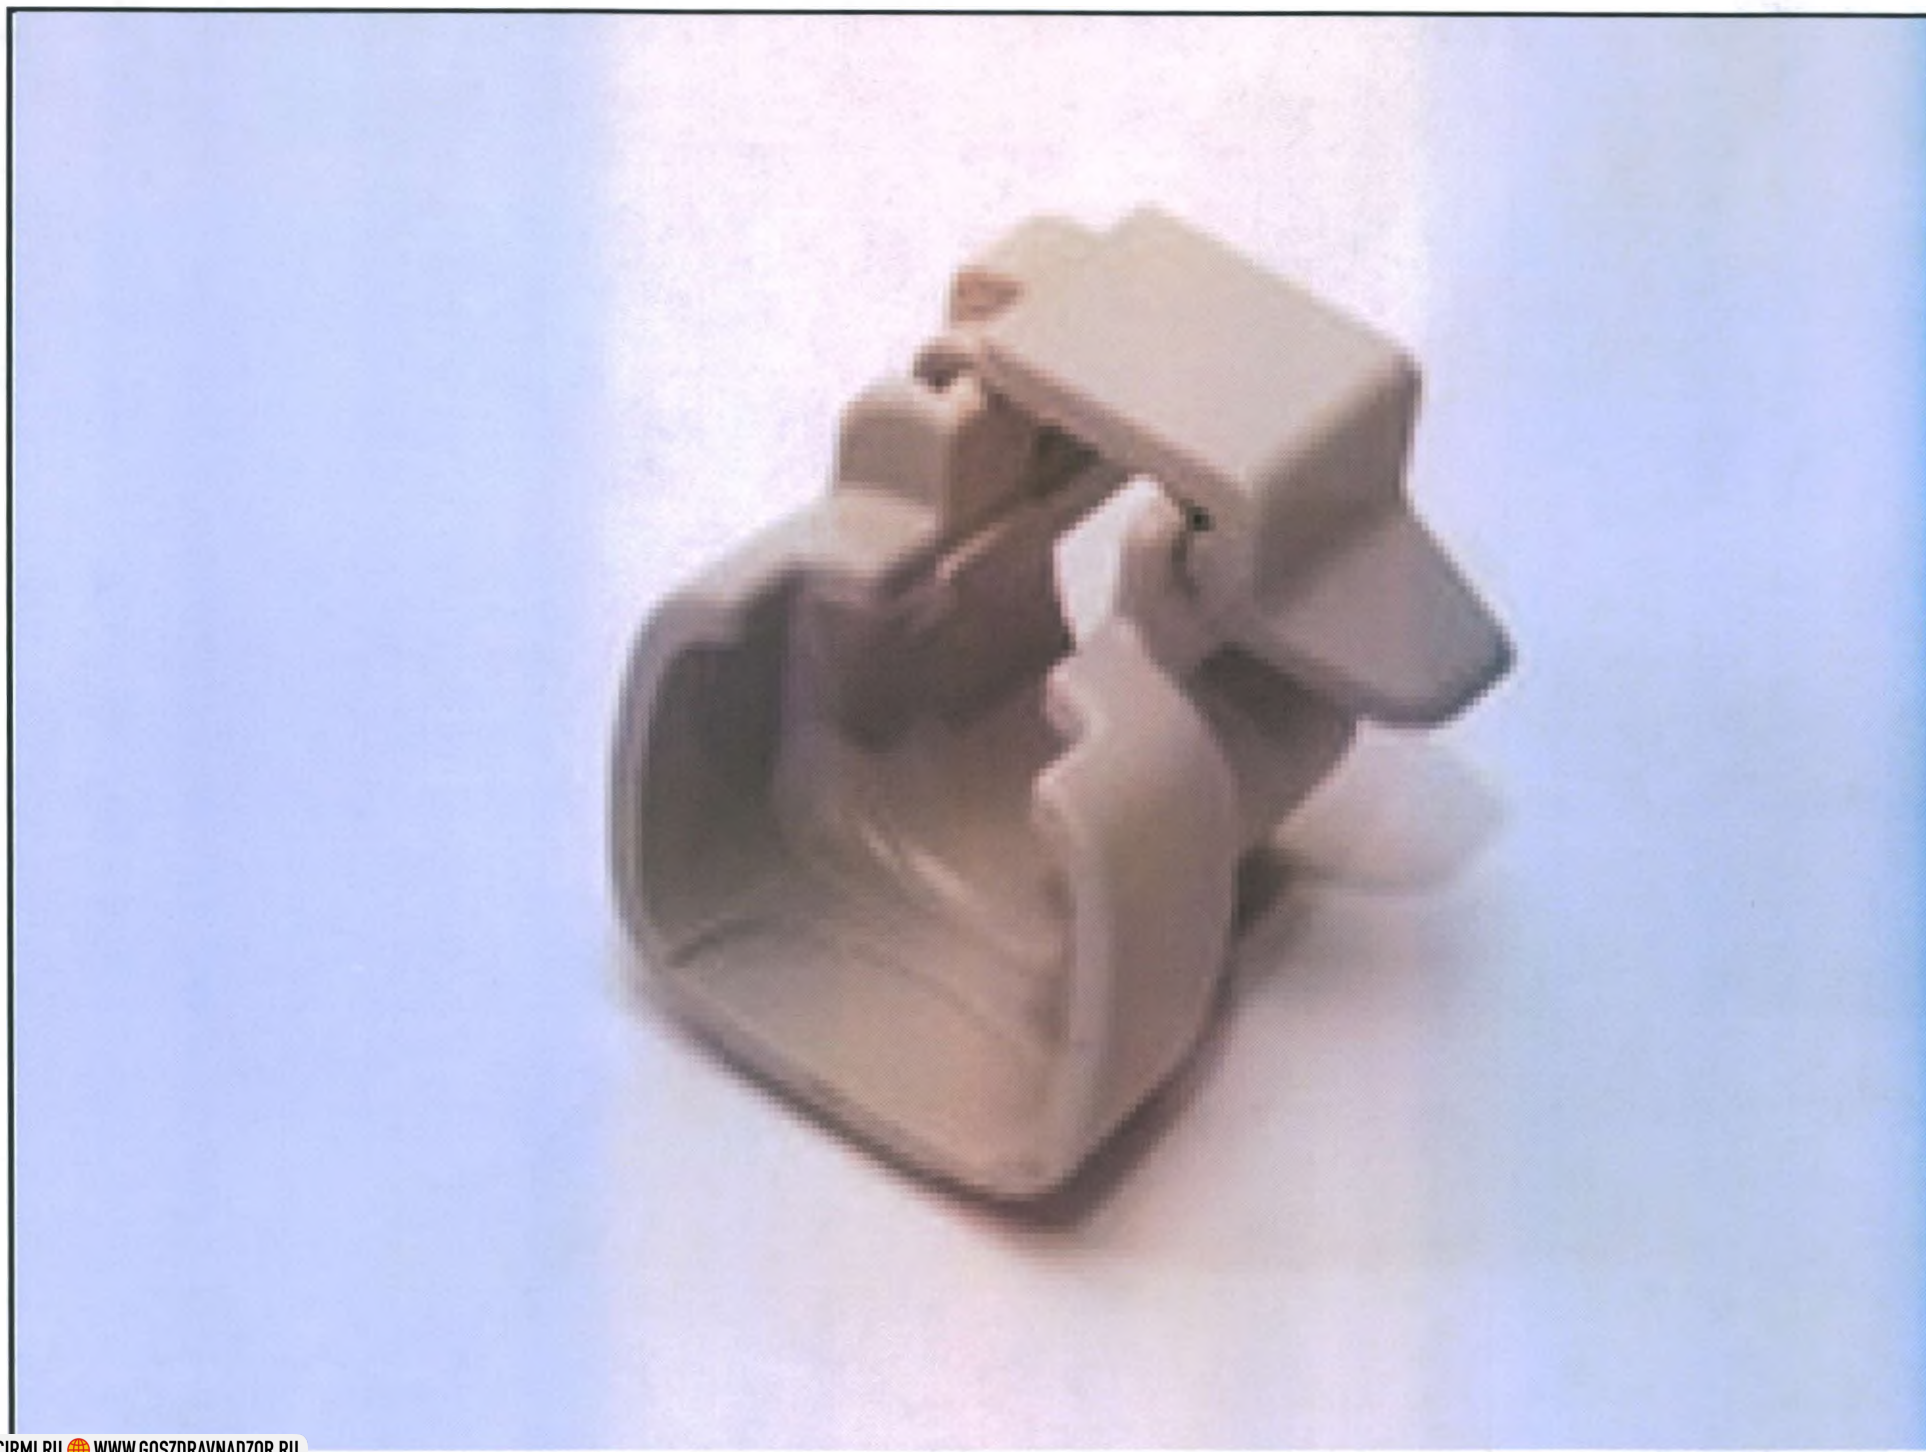




28. Адаптер для позиционирования сенсора, модель UAFS-002A





28. Адаптер для позиционирования сенсора, модель UAFS-002A

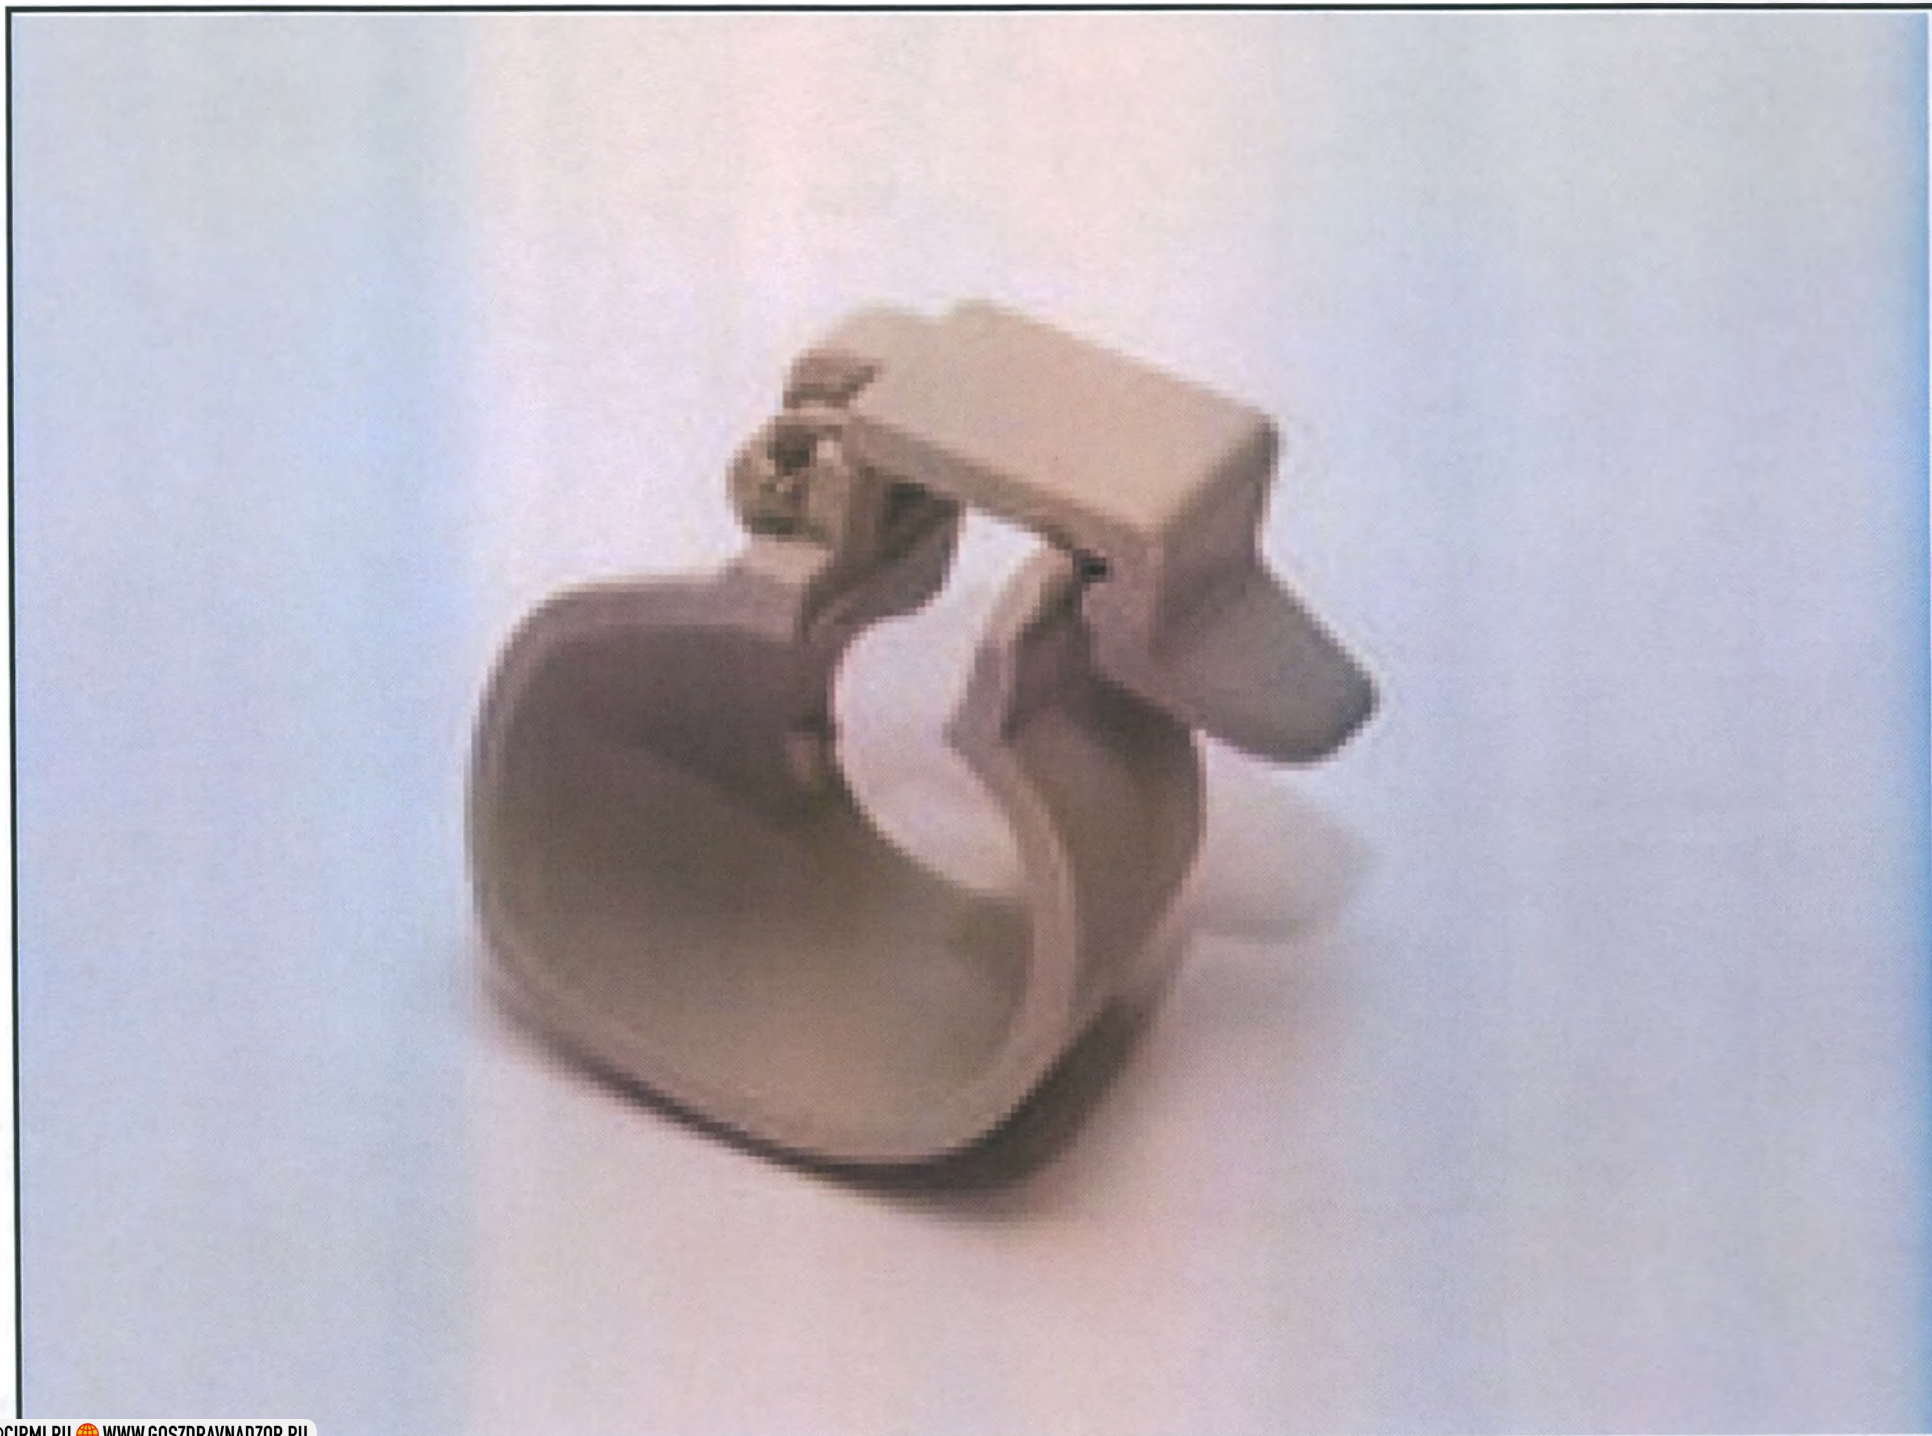




29. Адаптер для позиционирования сенсора, модель UAFS-003A






29. Адаптер для позиционирования сенсора, модель UAFS-003A

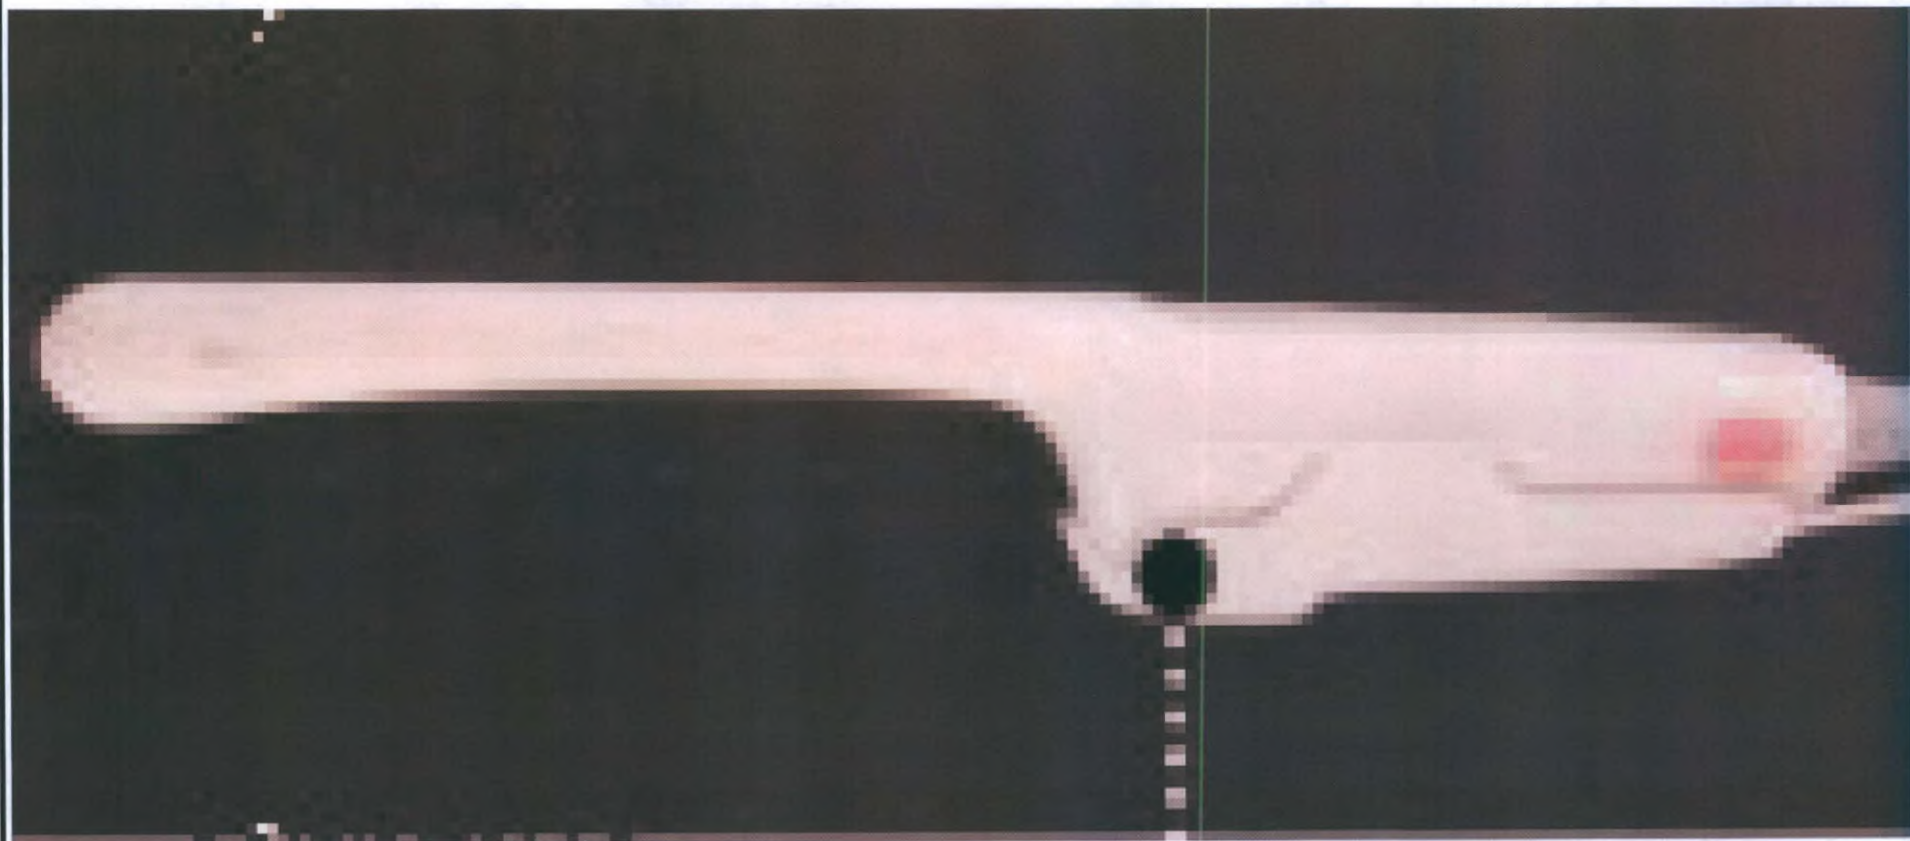



30. Адаптер для позиционирования сенсора, модель UAFS-004A

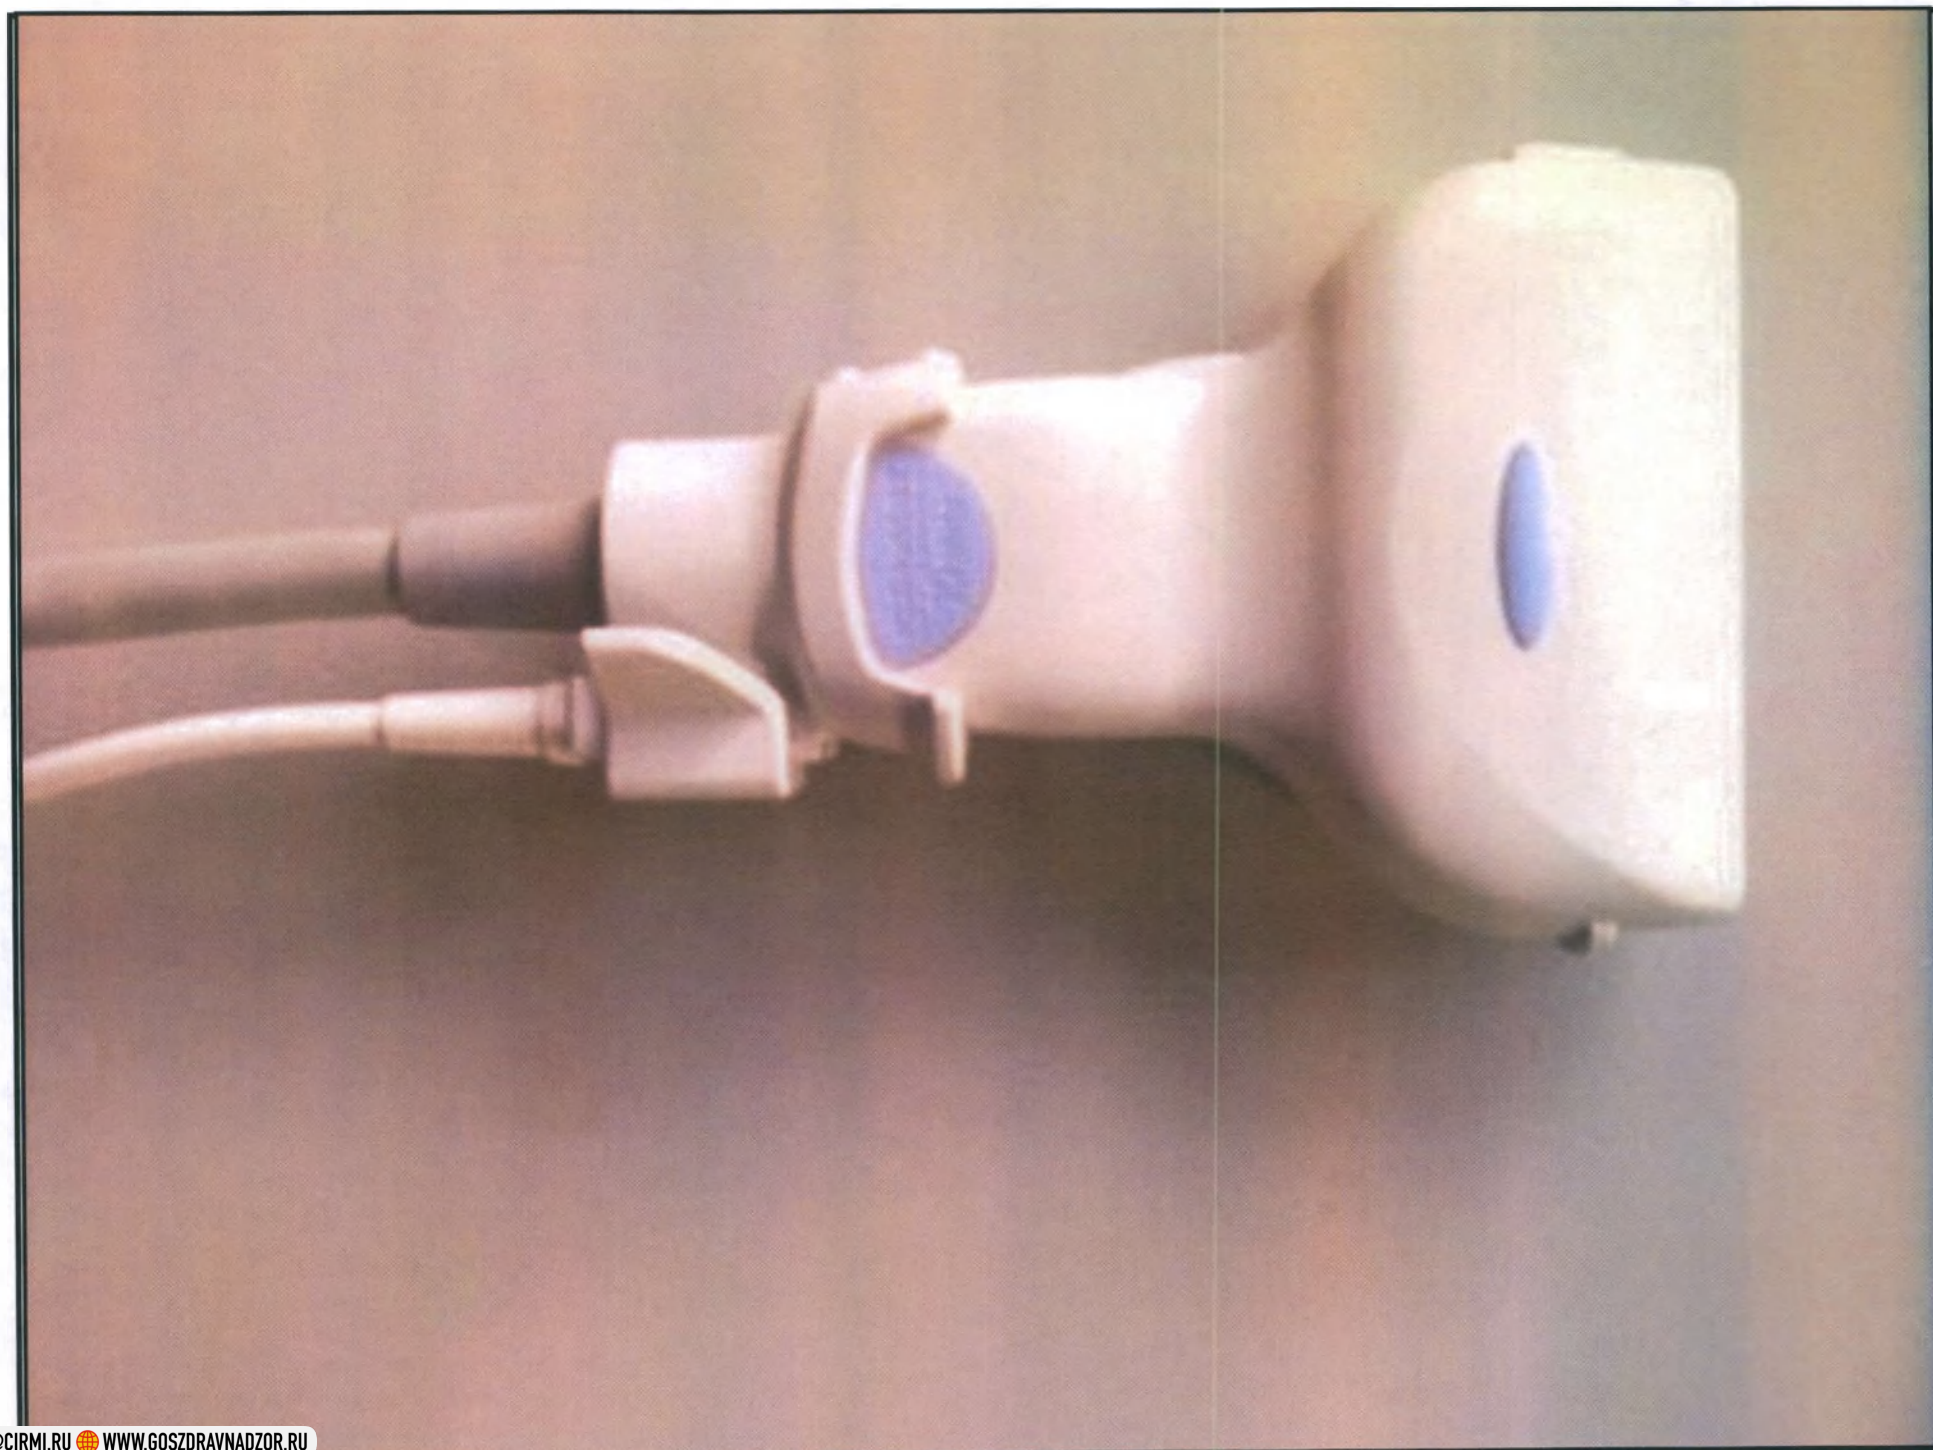




30. Адаптер для позиционирования сенсора, модель UAFS-004A






31. Адаптер для позиционирования сенсора, модель UAFS-005A

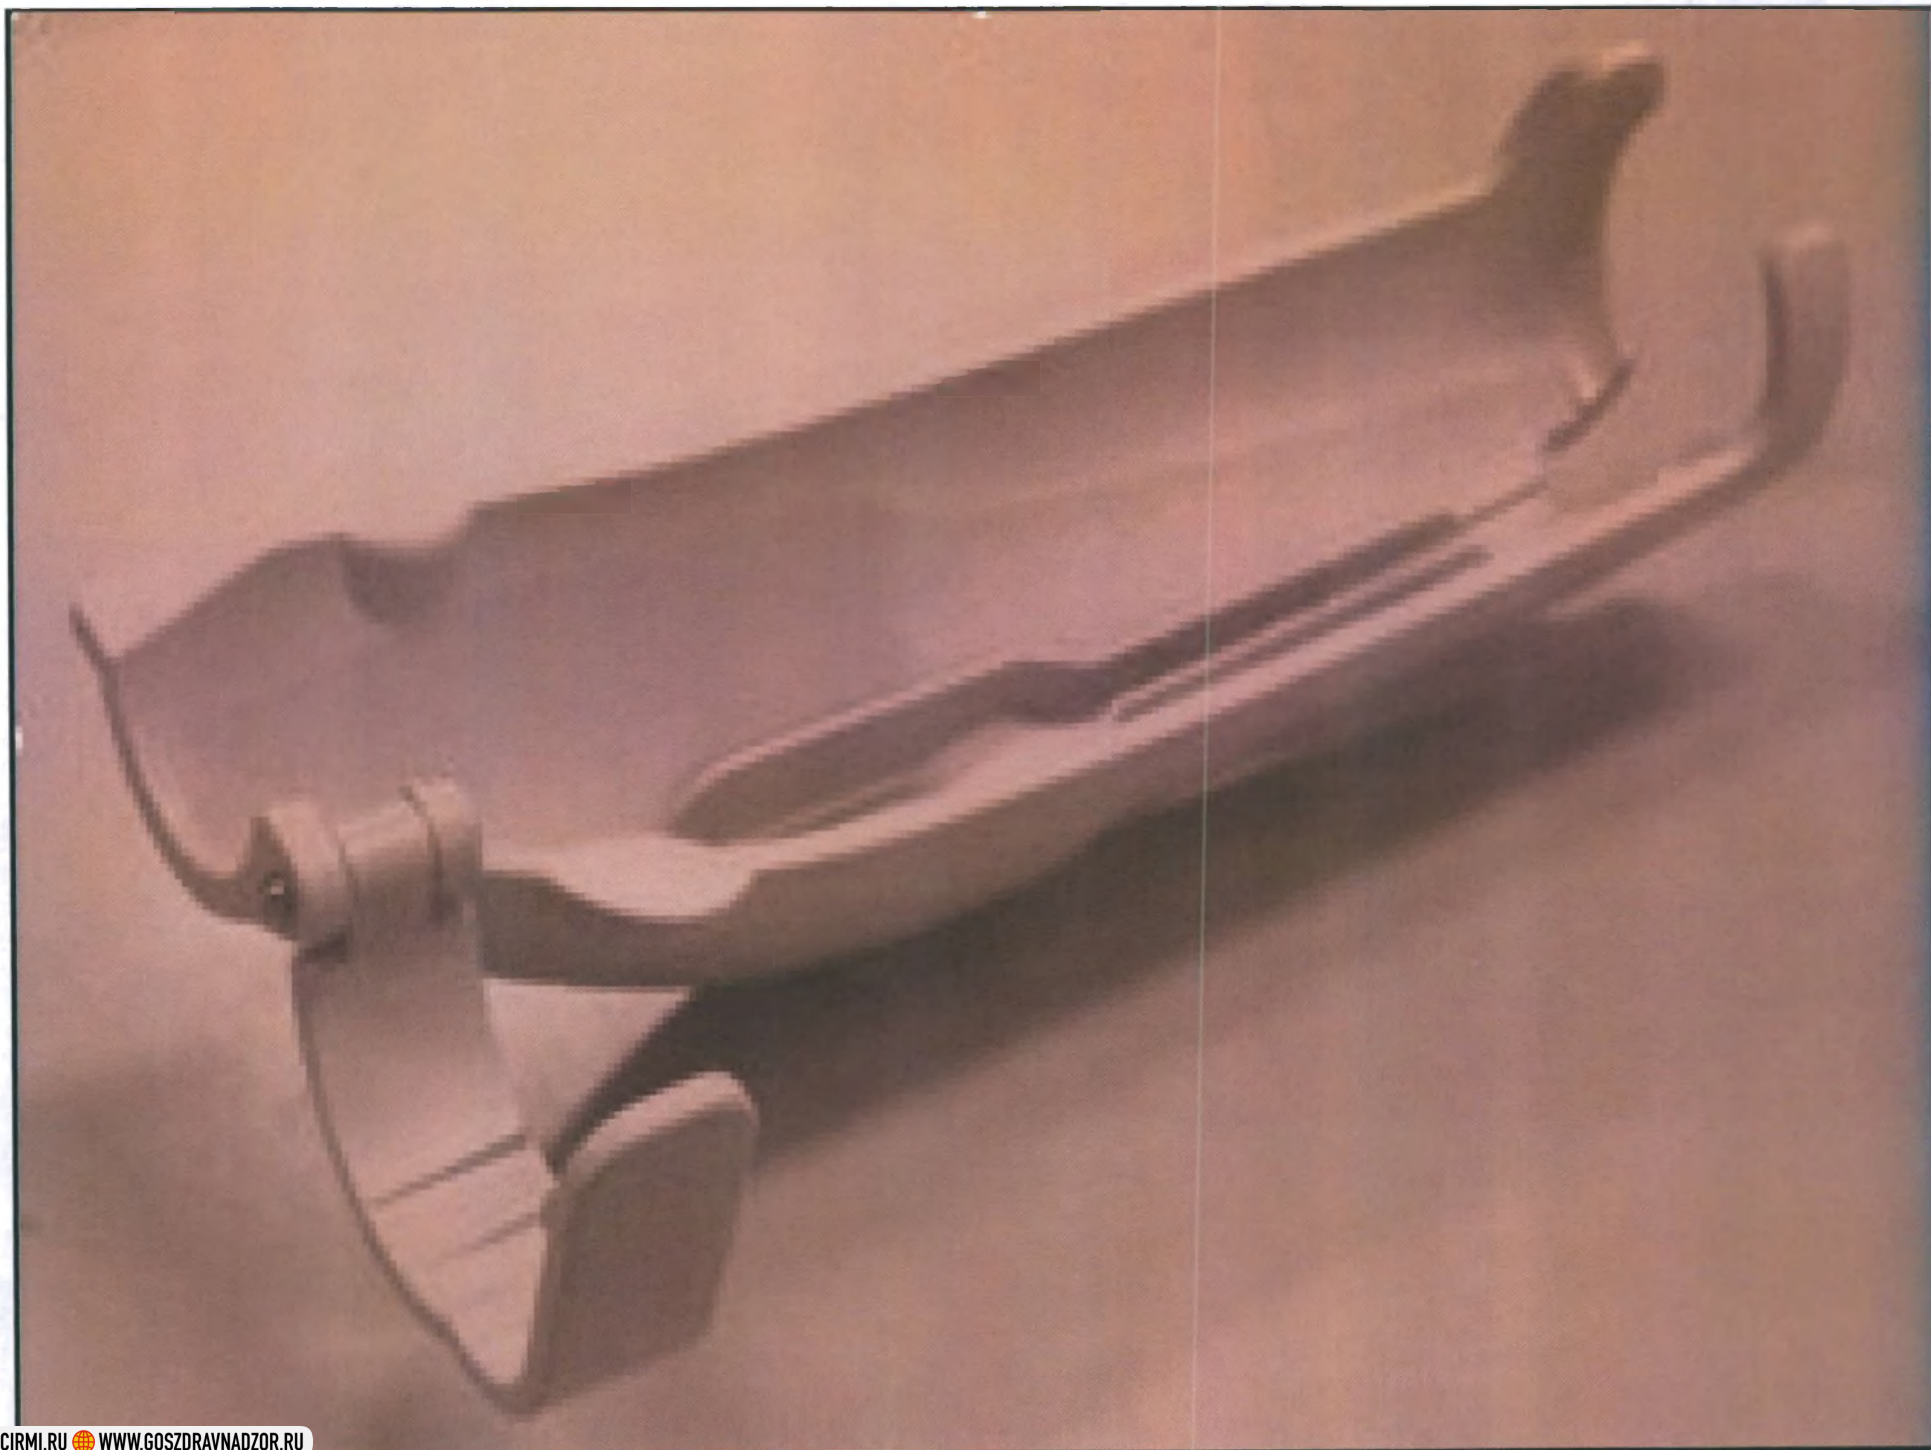




31. Адаптер для позиционирования сенсора, модель UAFS-005A

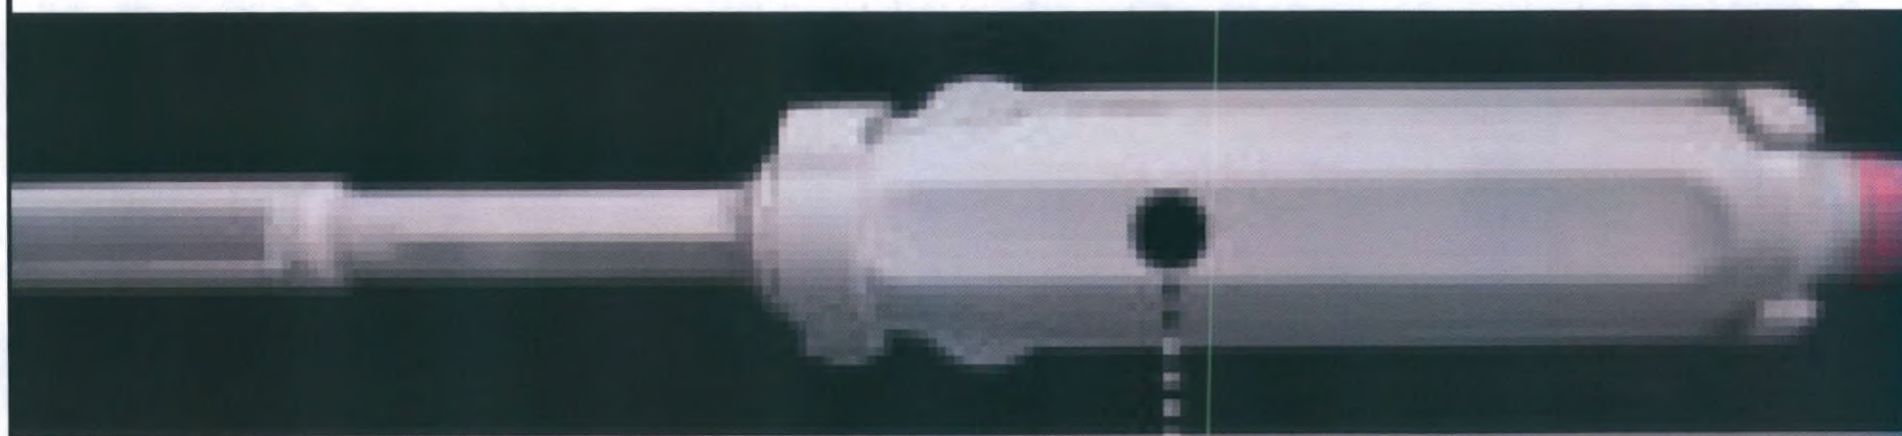



32. Адаптер для позиционирования сенсора, модель UAFS- 006A

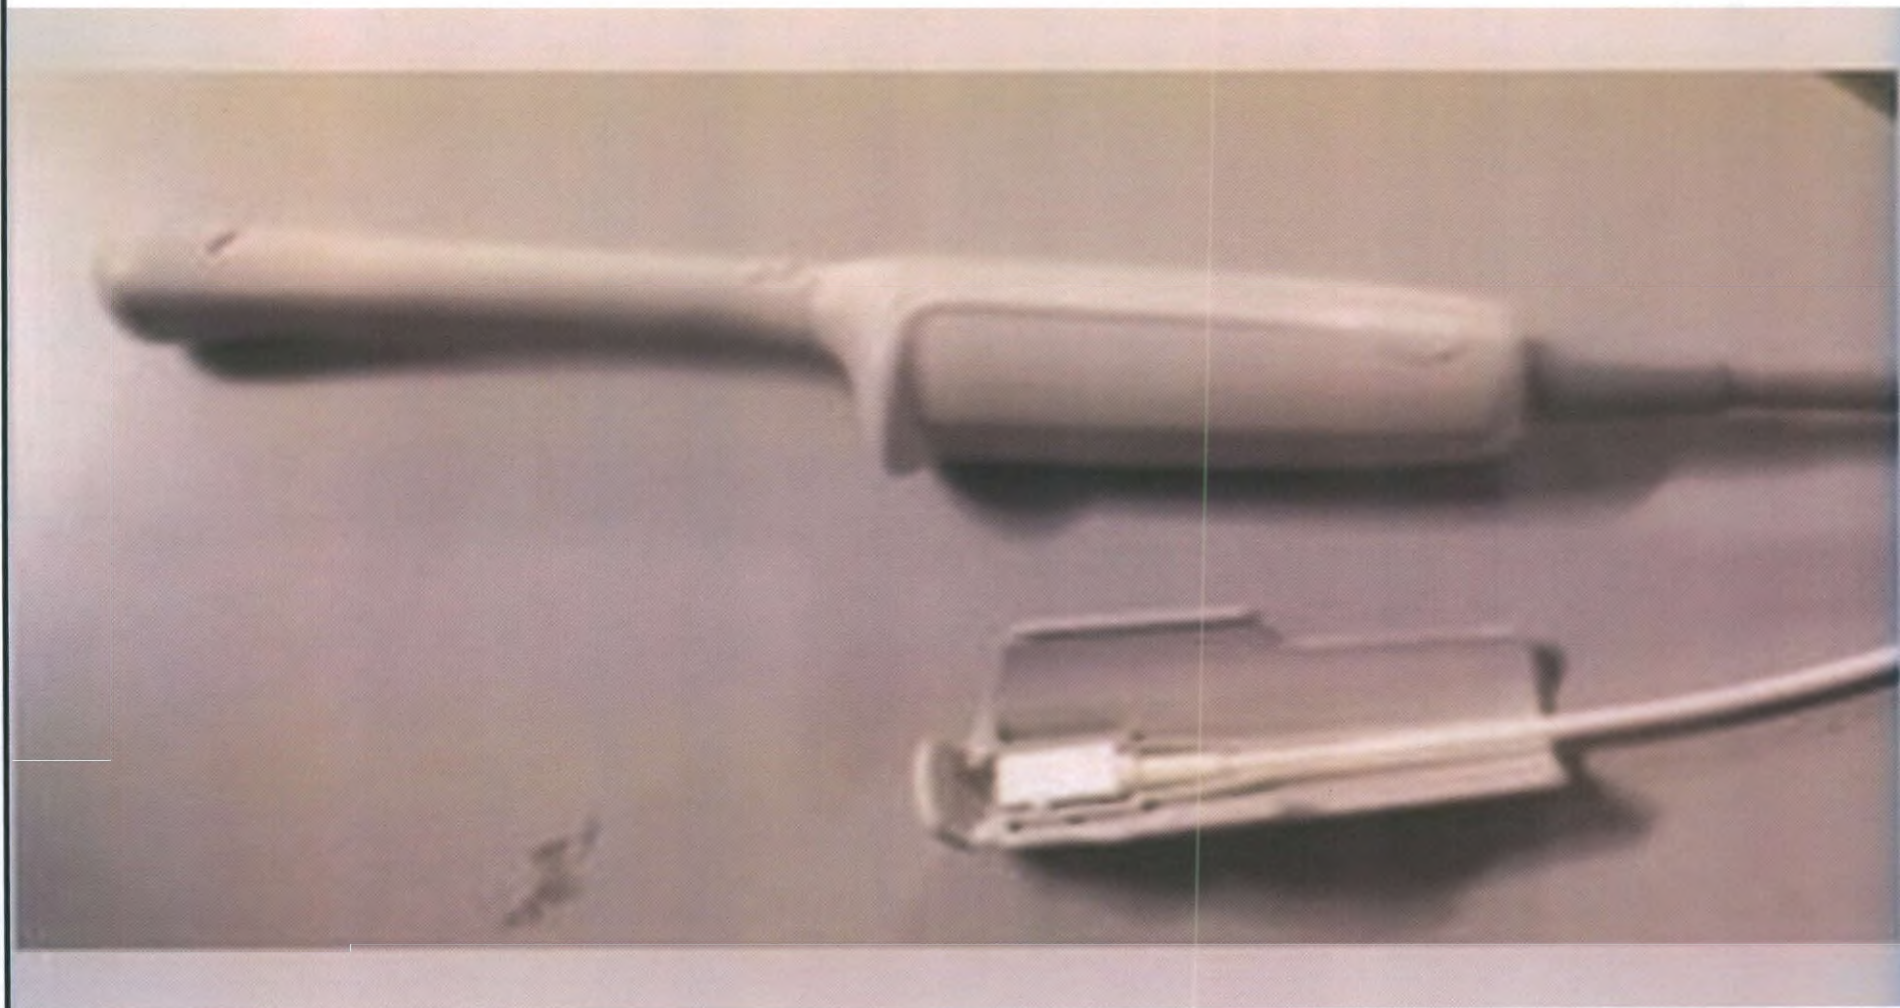



32. Адаптер для позиционирования сенсора, модель UAFS- 006A





33. Адаптер для позиционирования сенсора, модель UAFS-007A






33. Адаптер для позиционирования сенсора, модель UAFS-007A






34. Адаптер для позиционирования сенсора, модель UAFS-010A

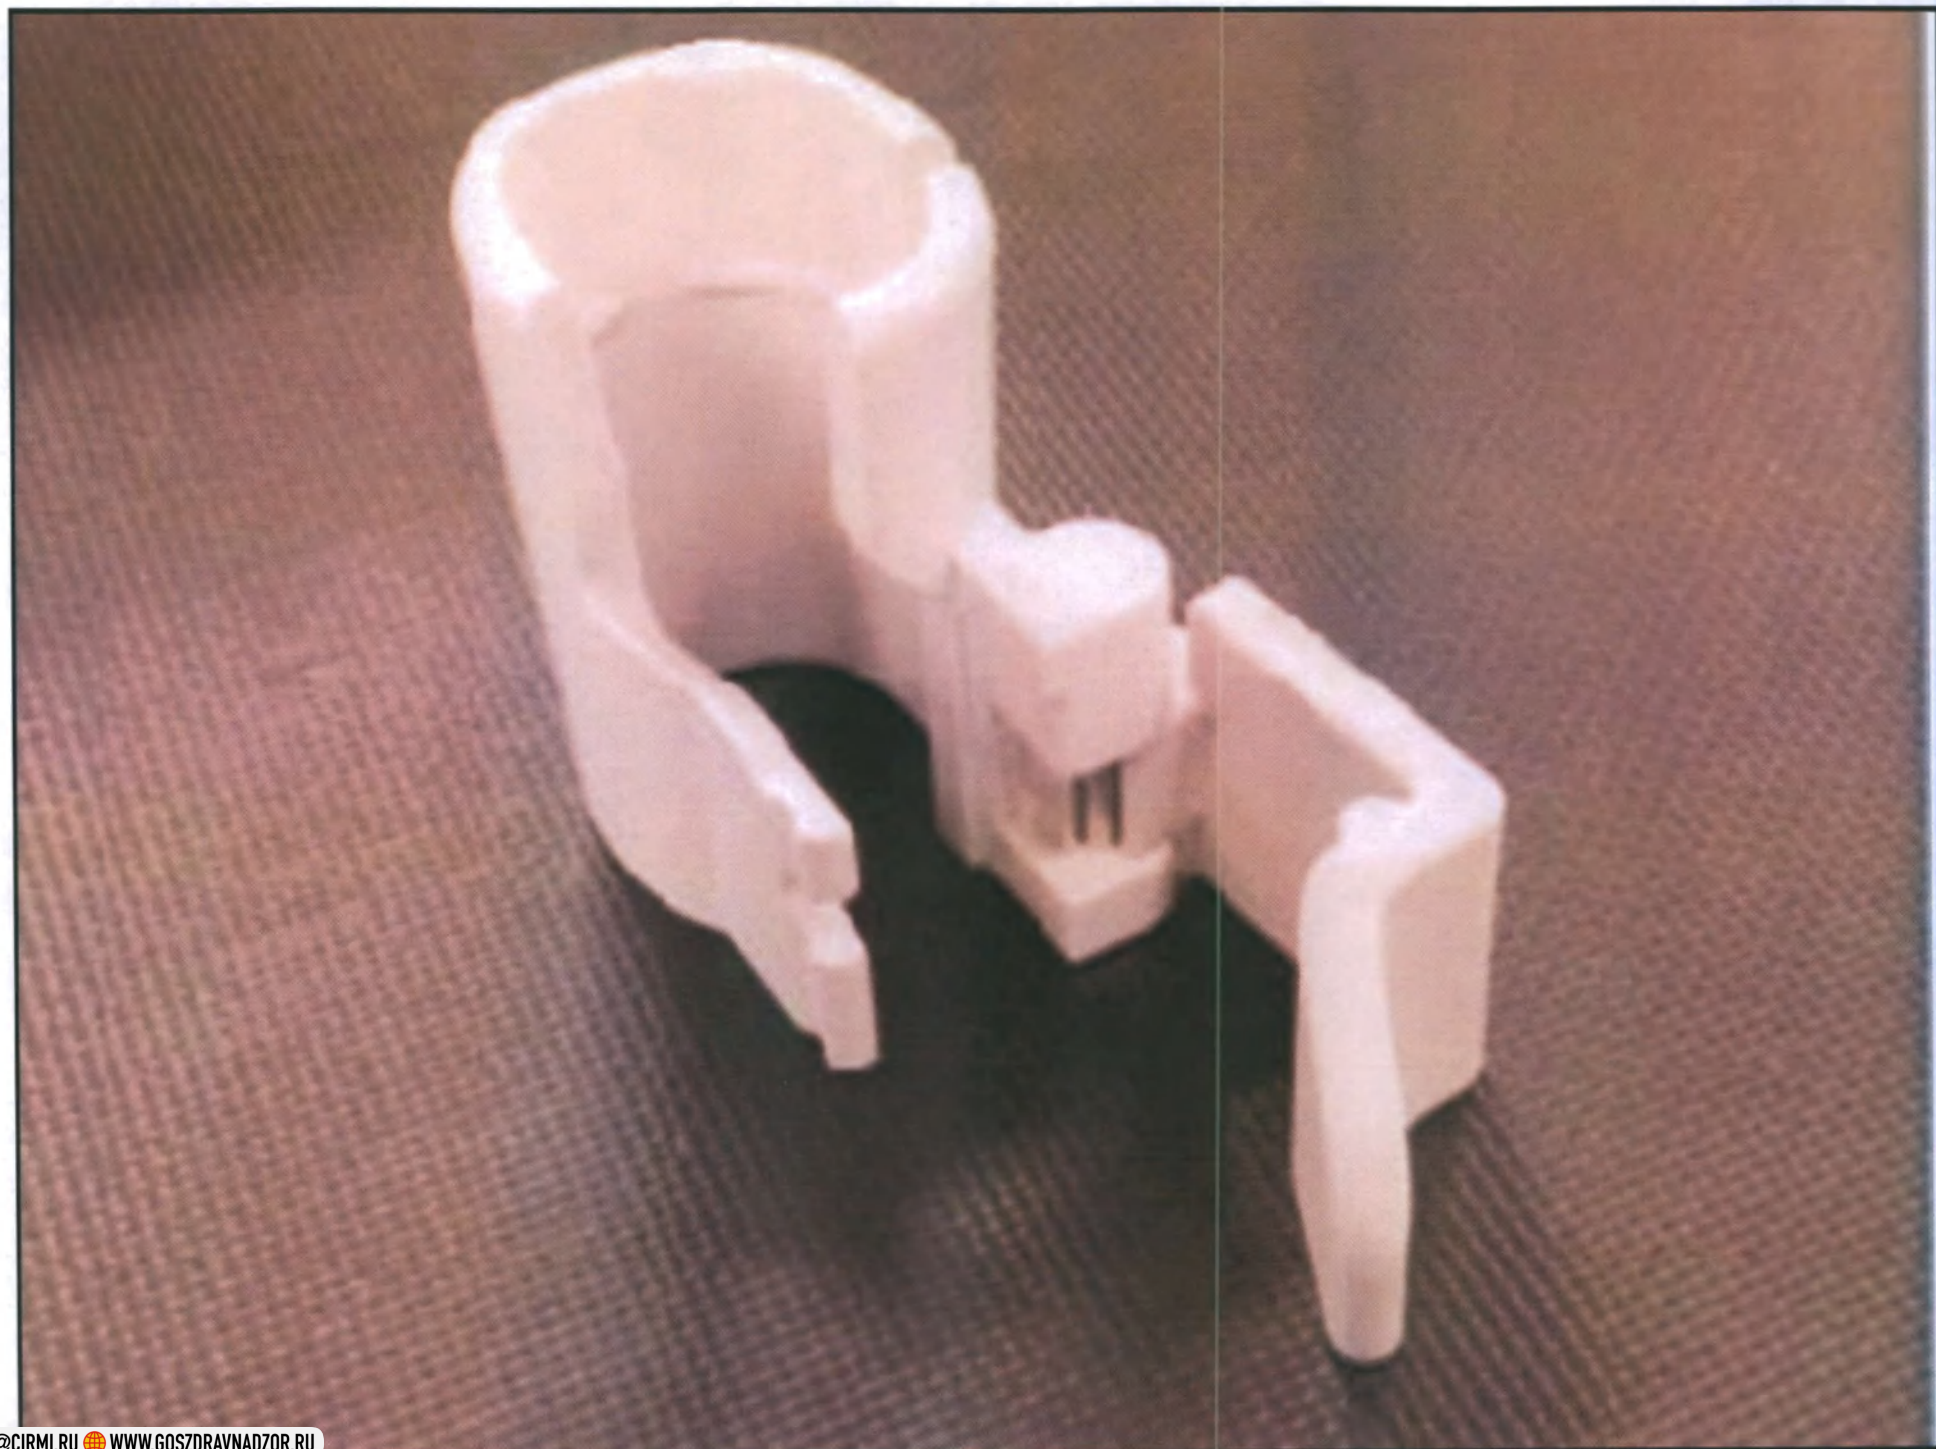




34. Адаптер для позиционирования сенсора, модель UAFS-010A

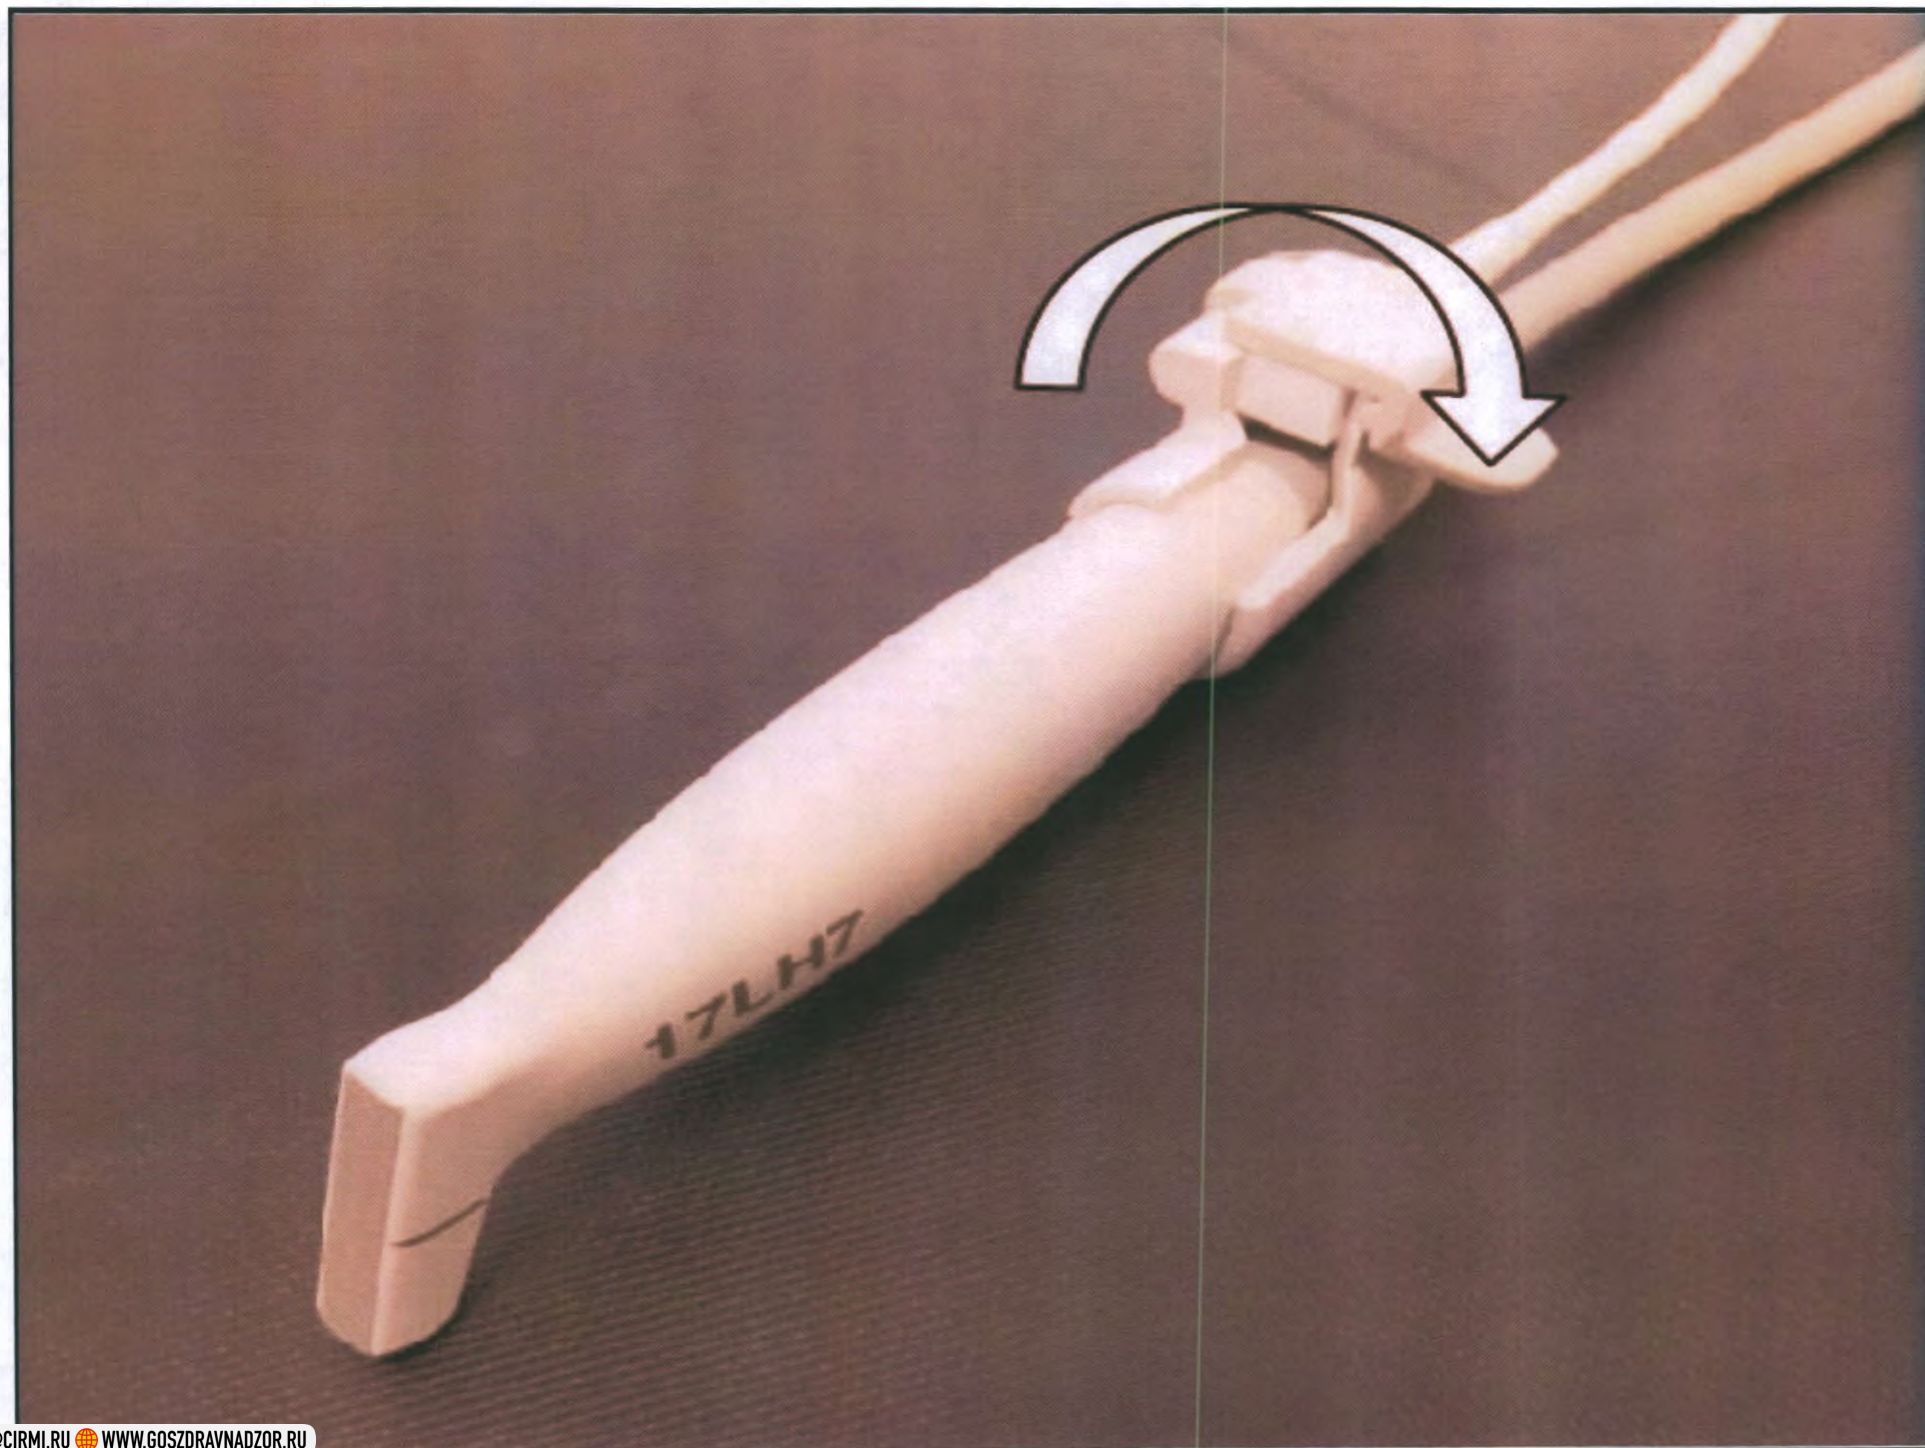




## 35. Программное приложение для высококачественной визуализации микрососудов (Superb Micro Vascular Imaging)

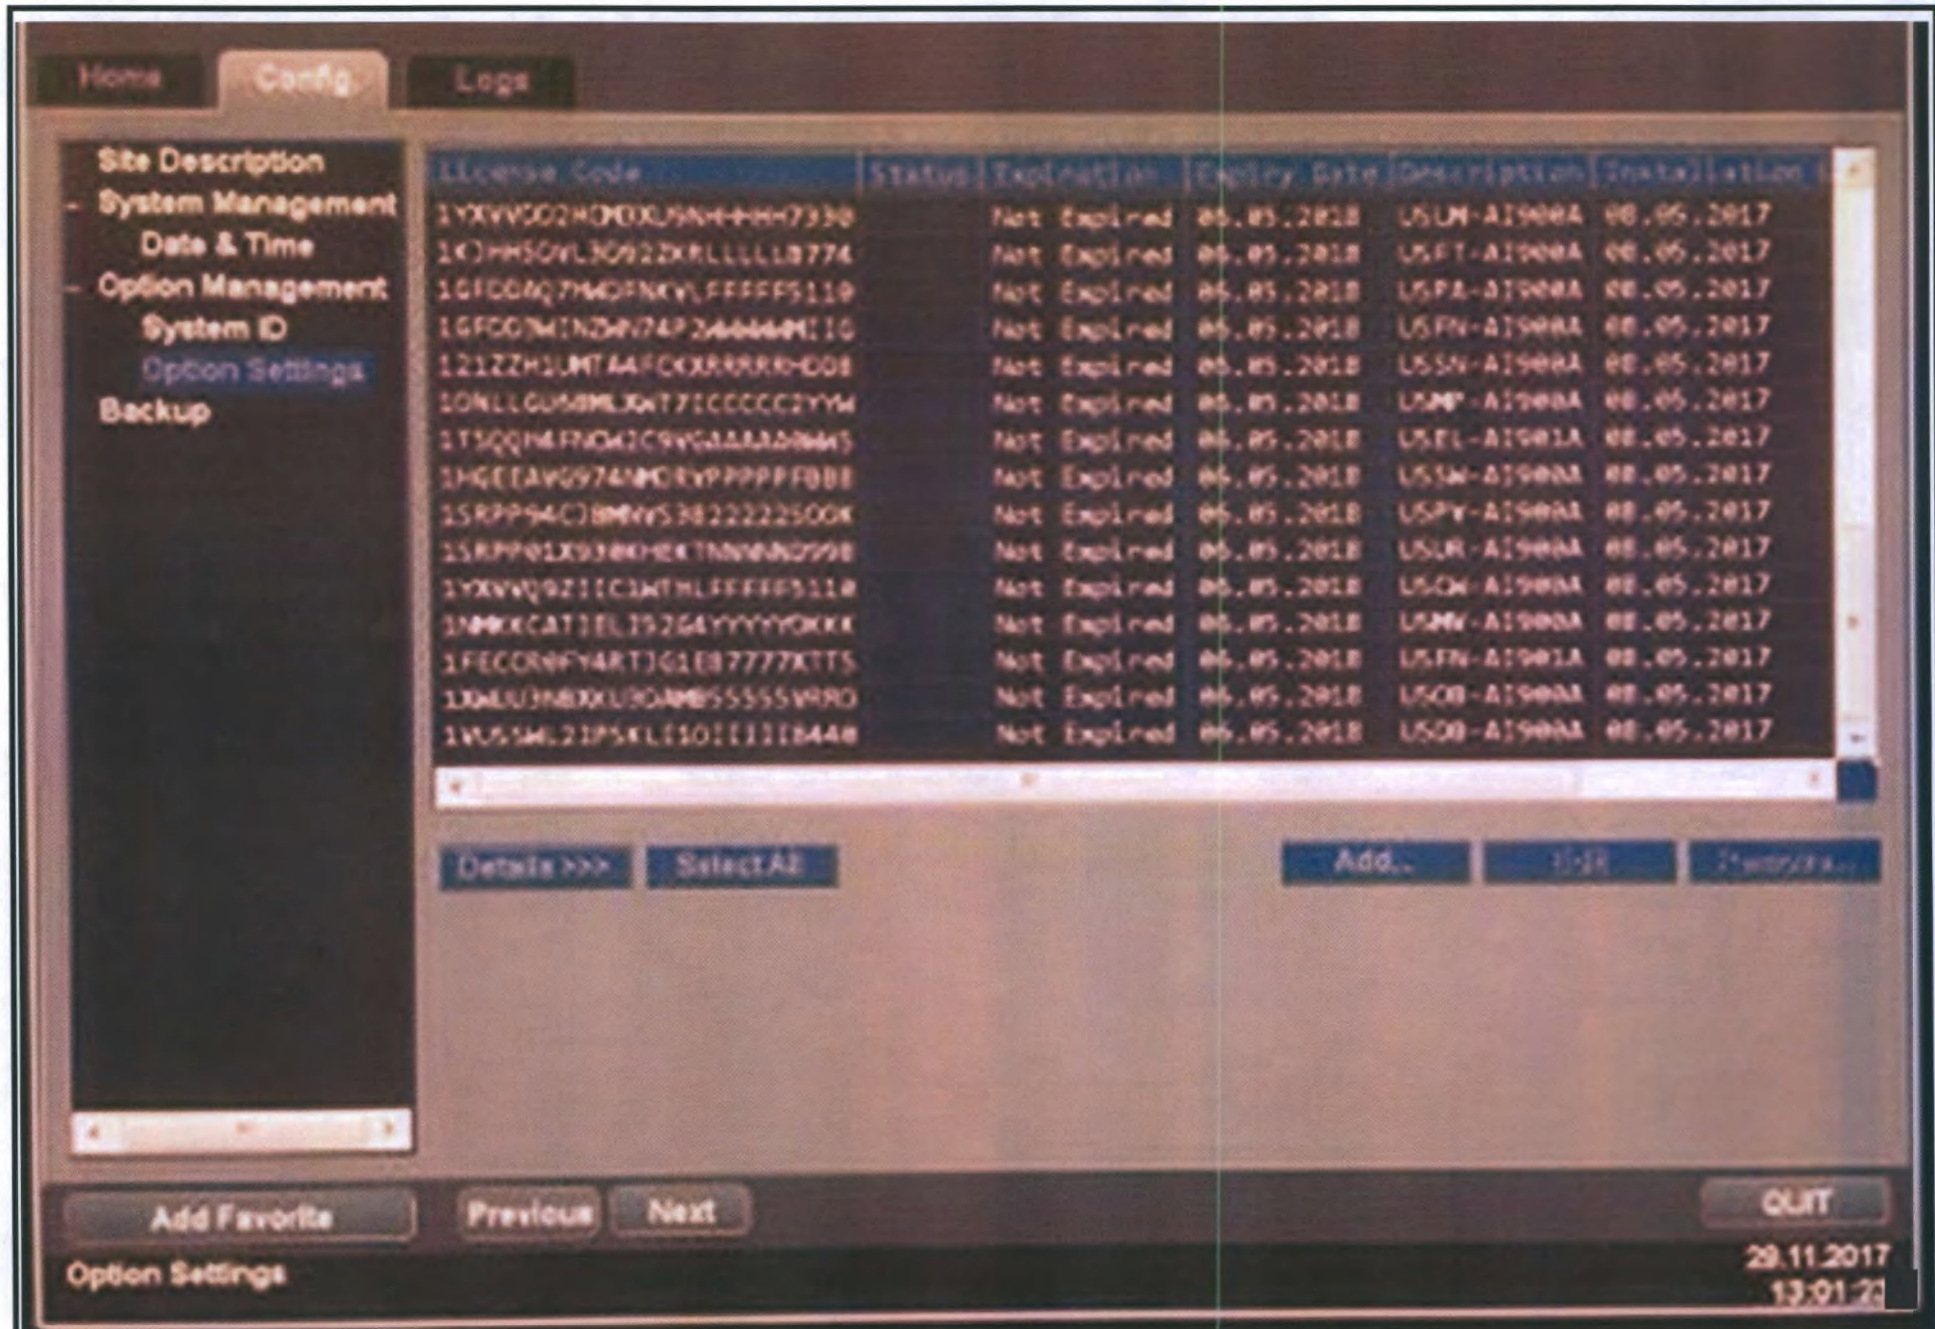




## 36. Программное приложение для функции Smart Sensor 3D

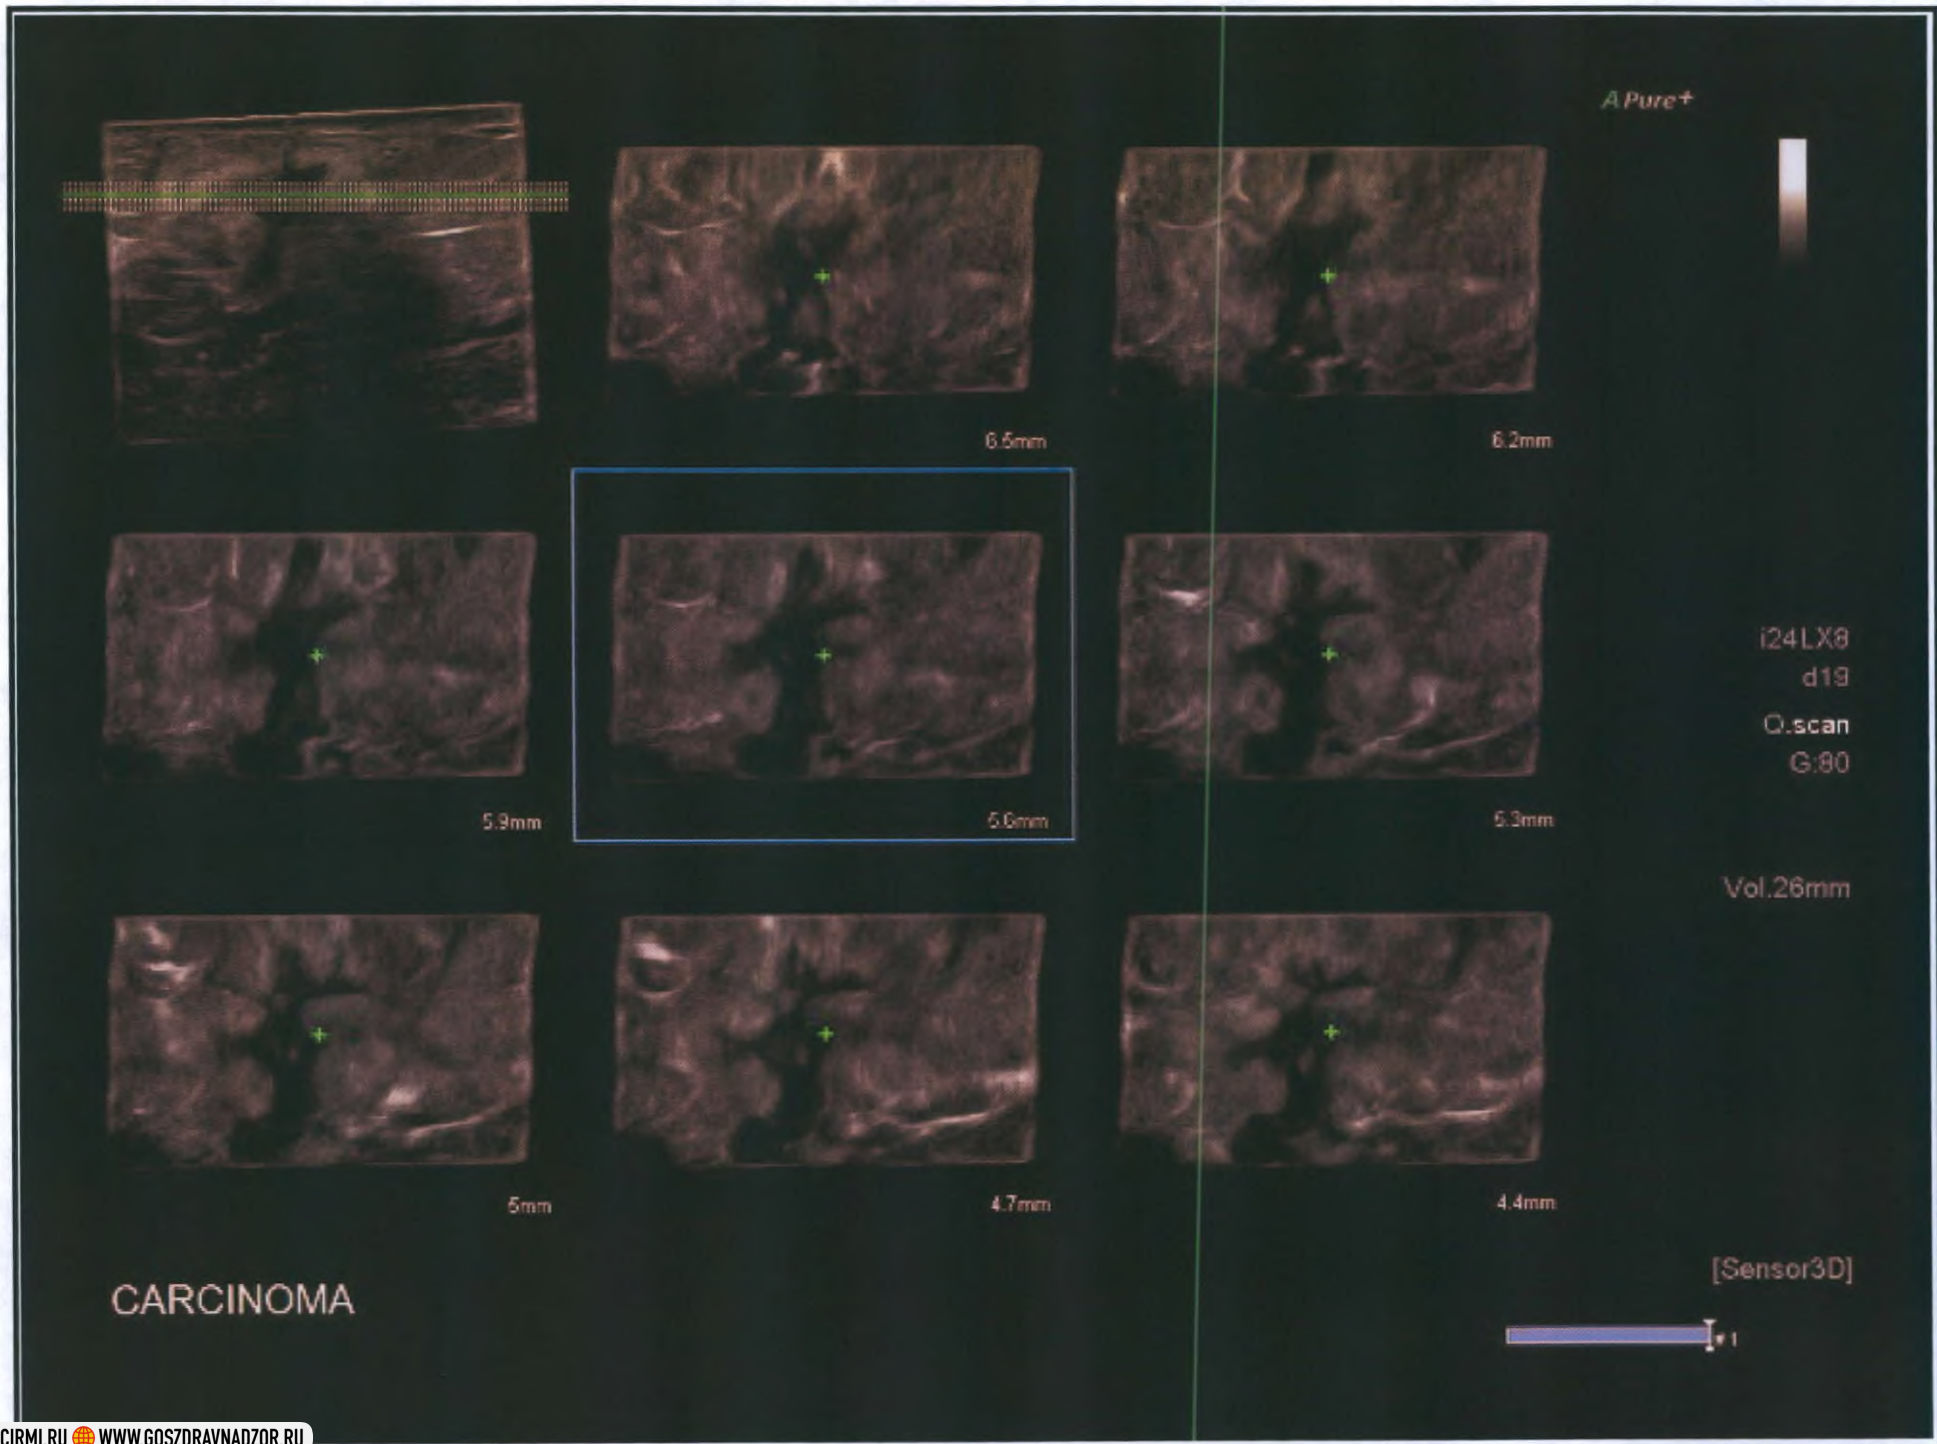




37. Программное приложение для выявления микрокальцинатов (MicroPure)

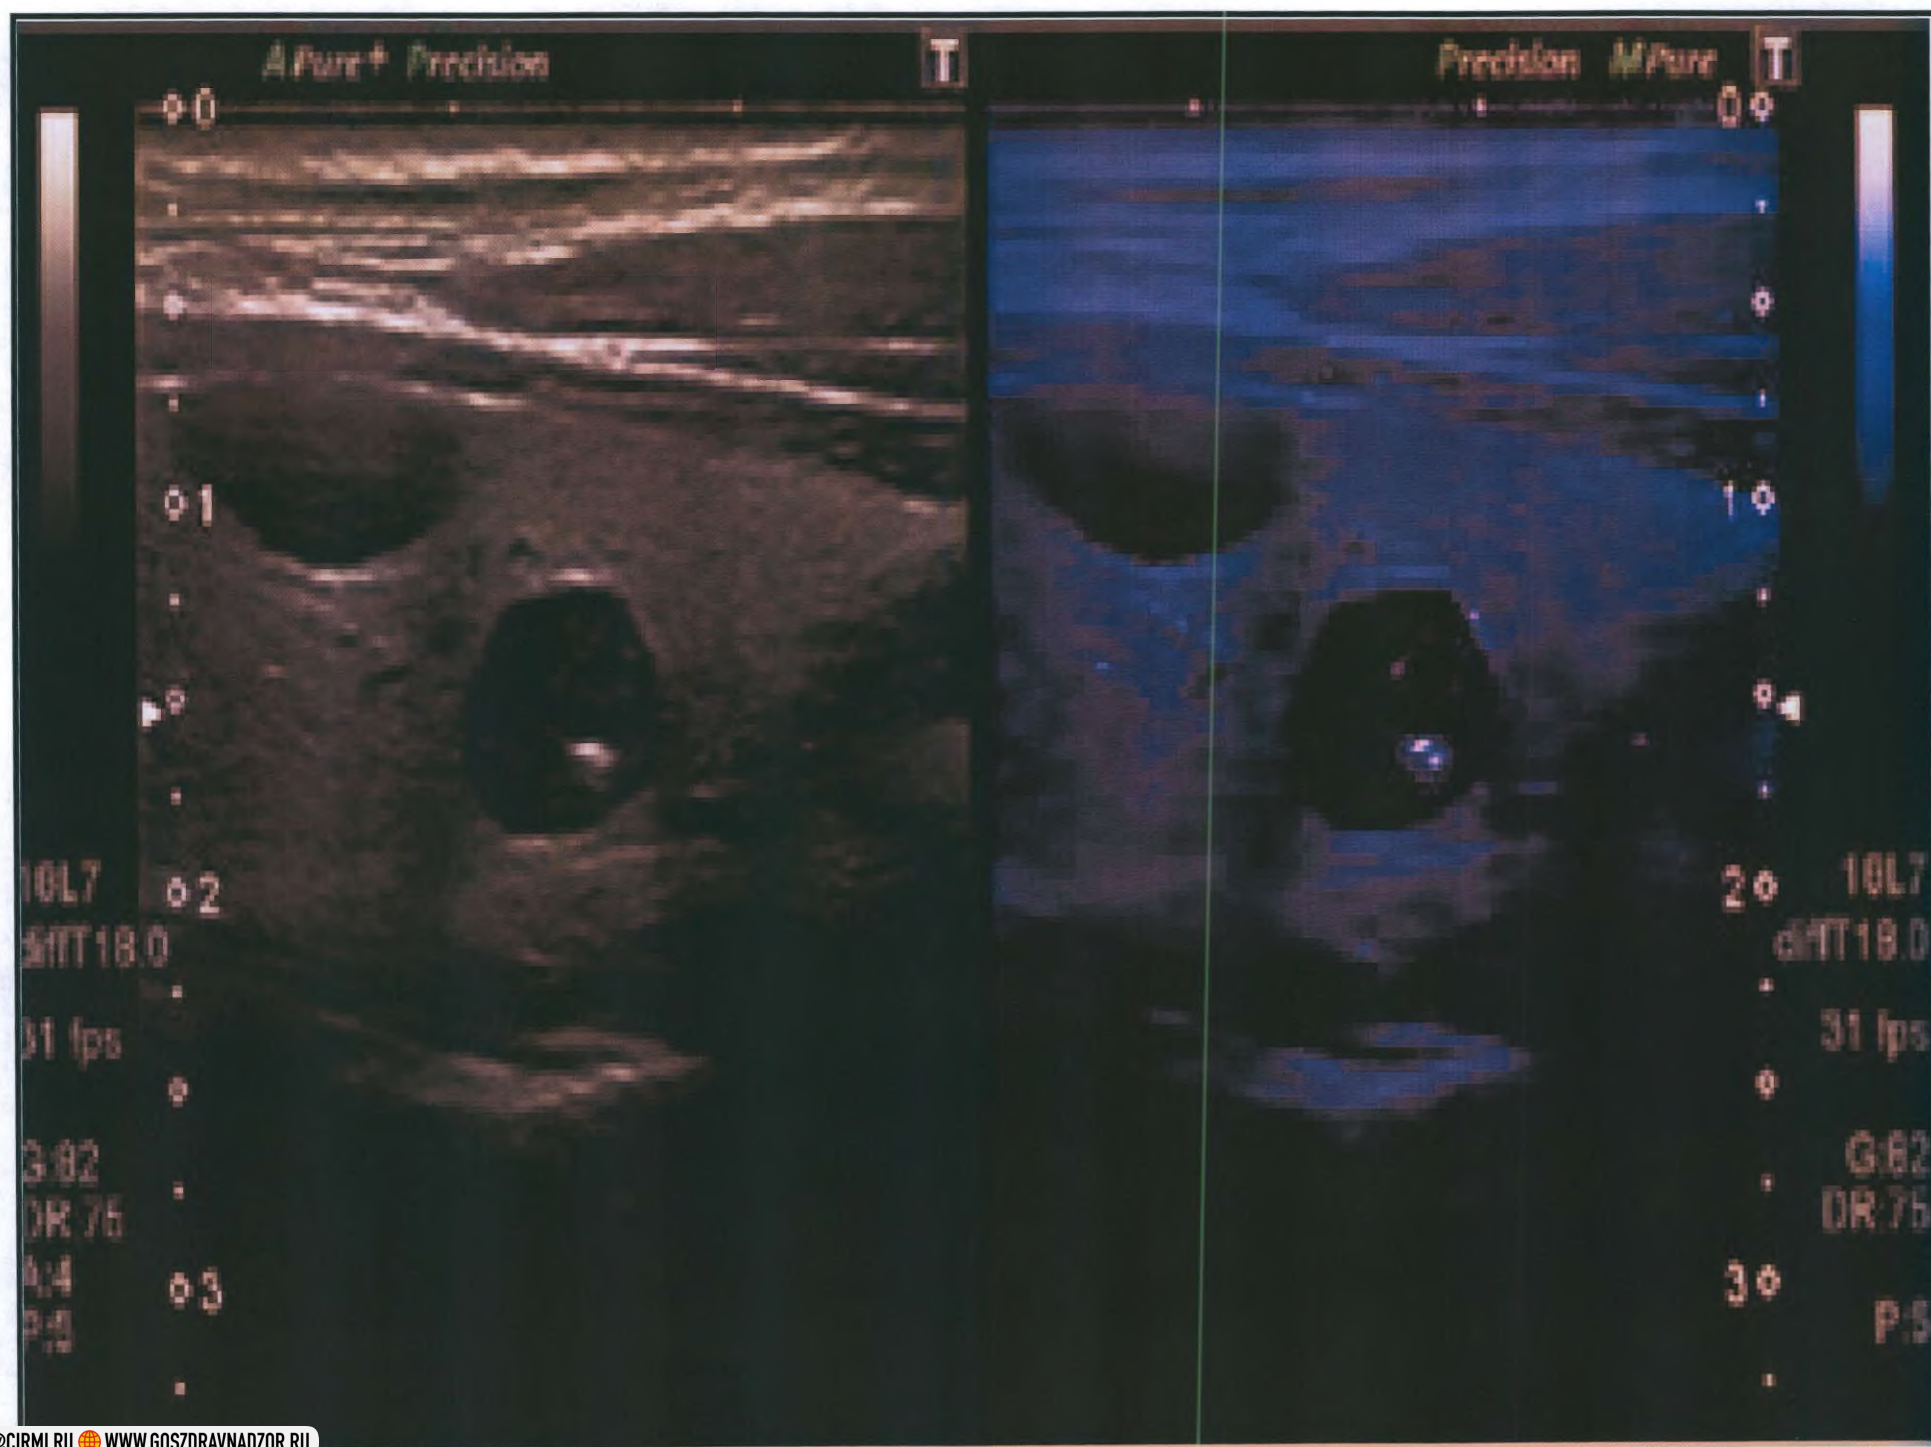




## 38. Программное приложение для панорамной реконструкции изображения (Panoramic View)

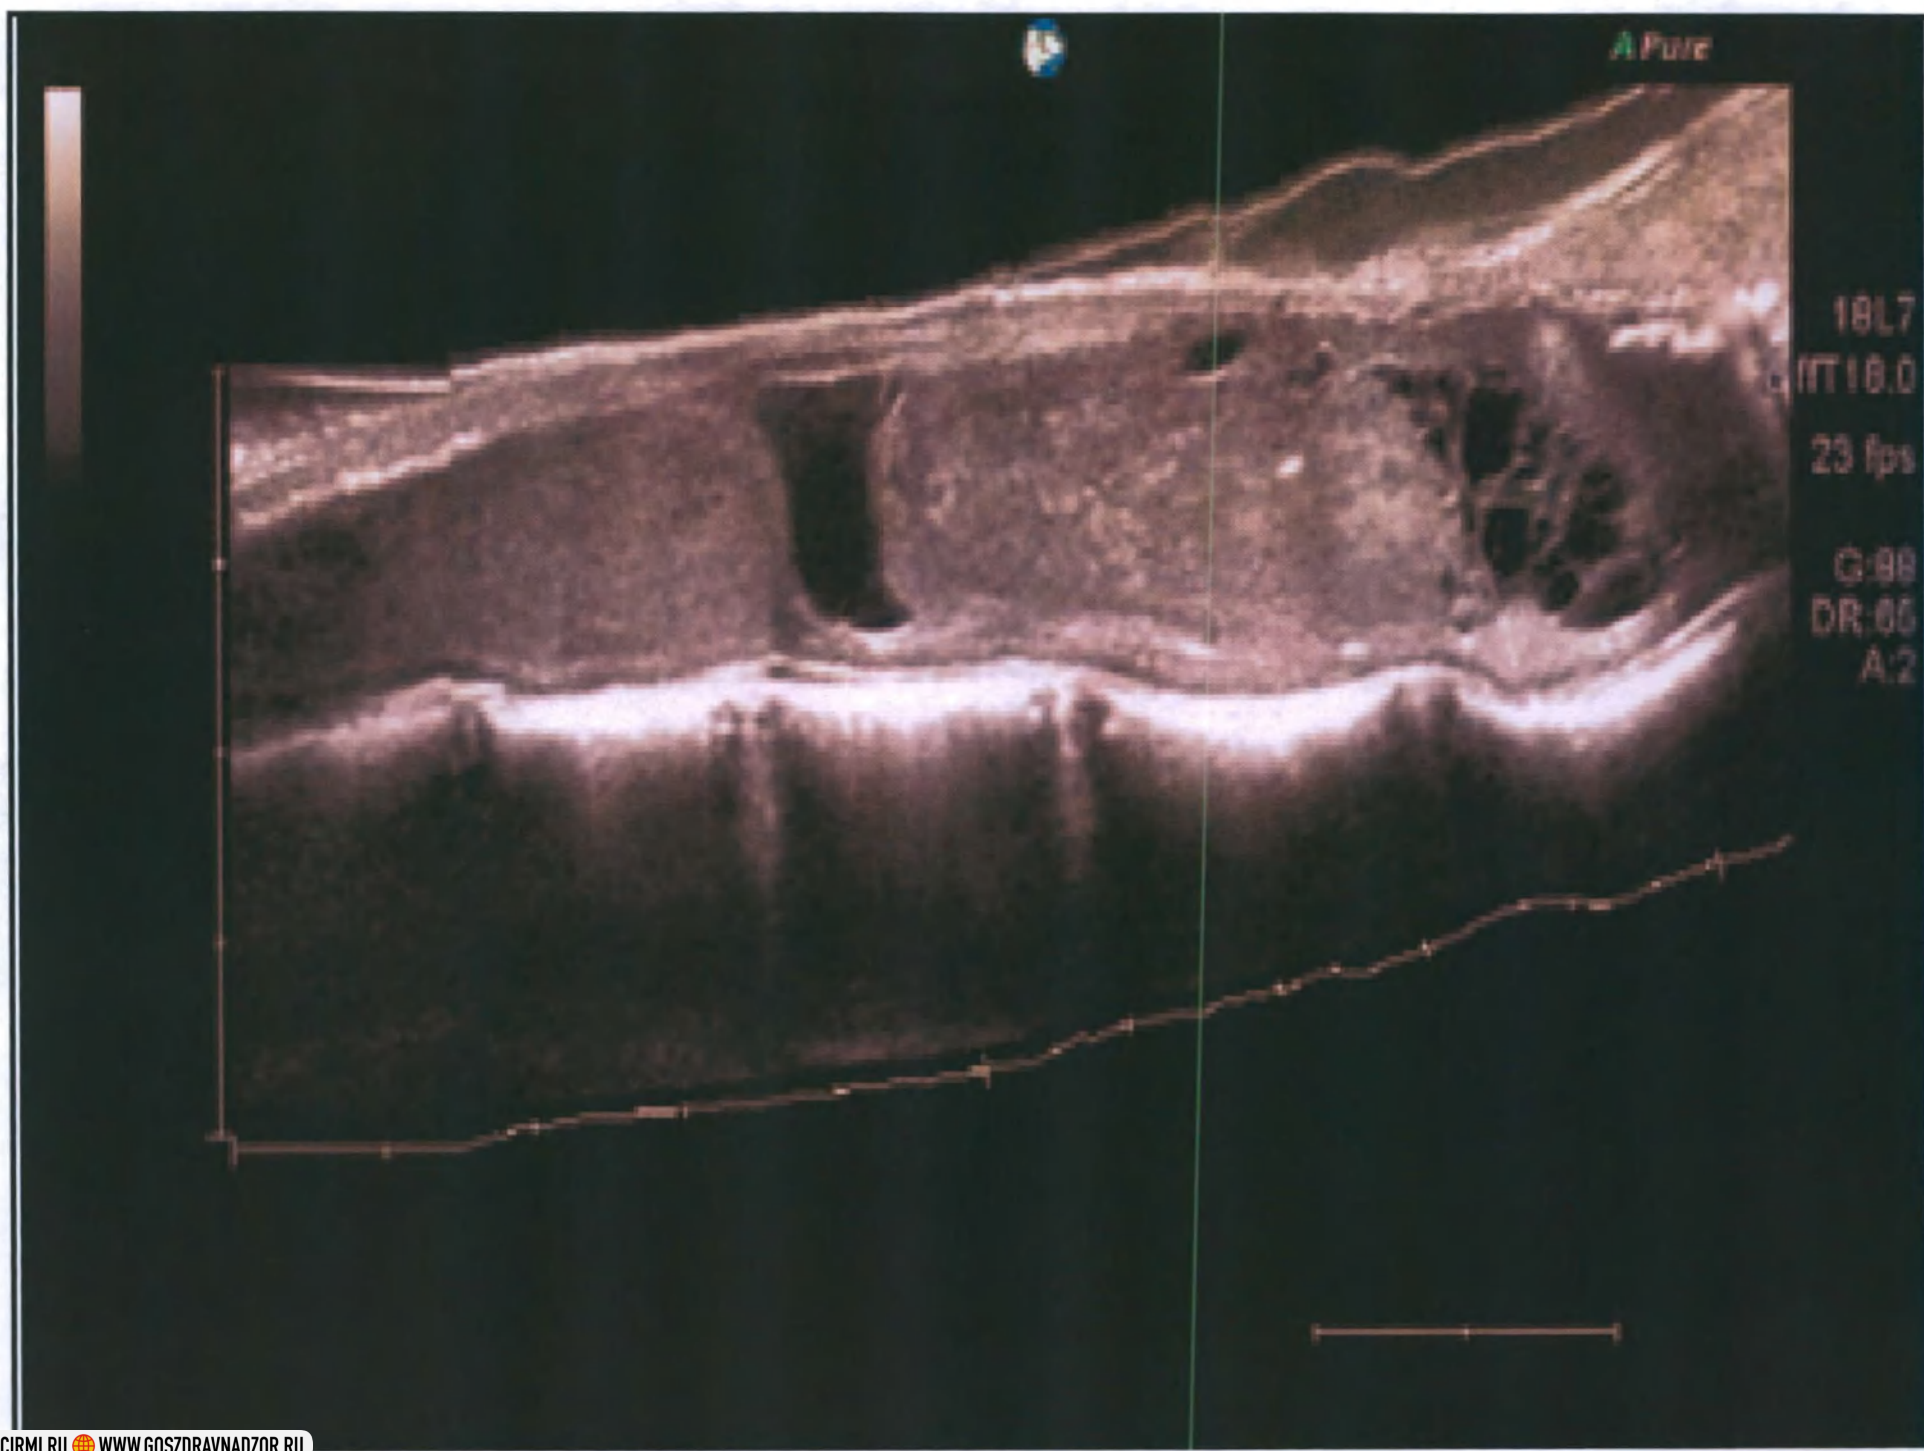




## 39. Программное приложение для подавления артефактов (Multi-Reflection Canceller)

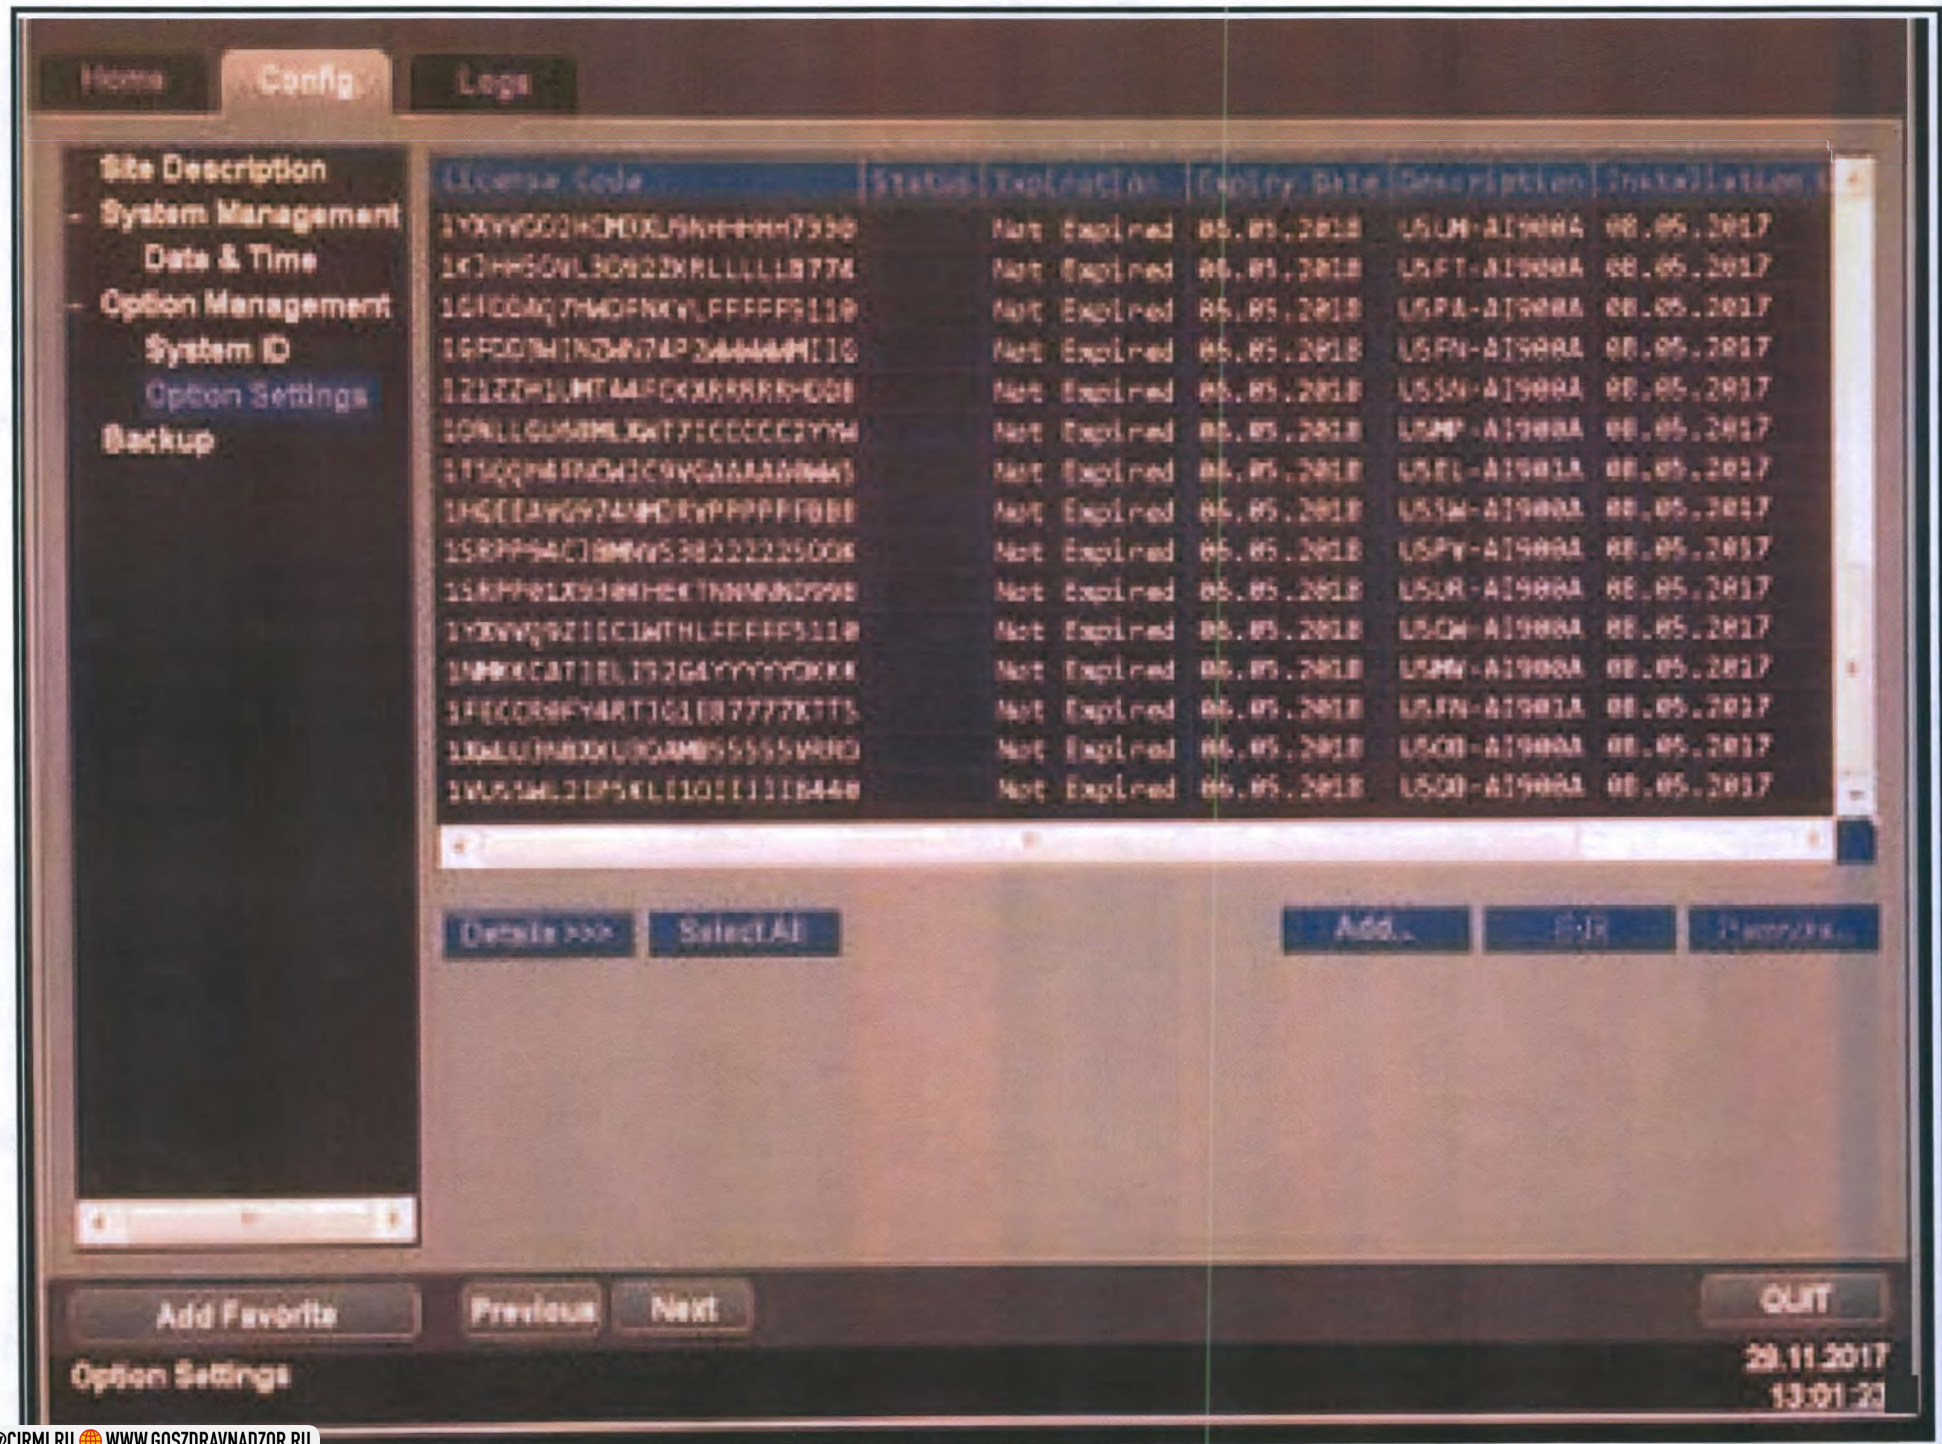




40. Программное приложение для измерения миокардиального индекса сердца плода (Fetal Heart MPI)

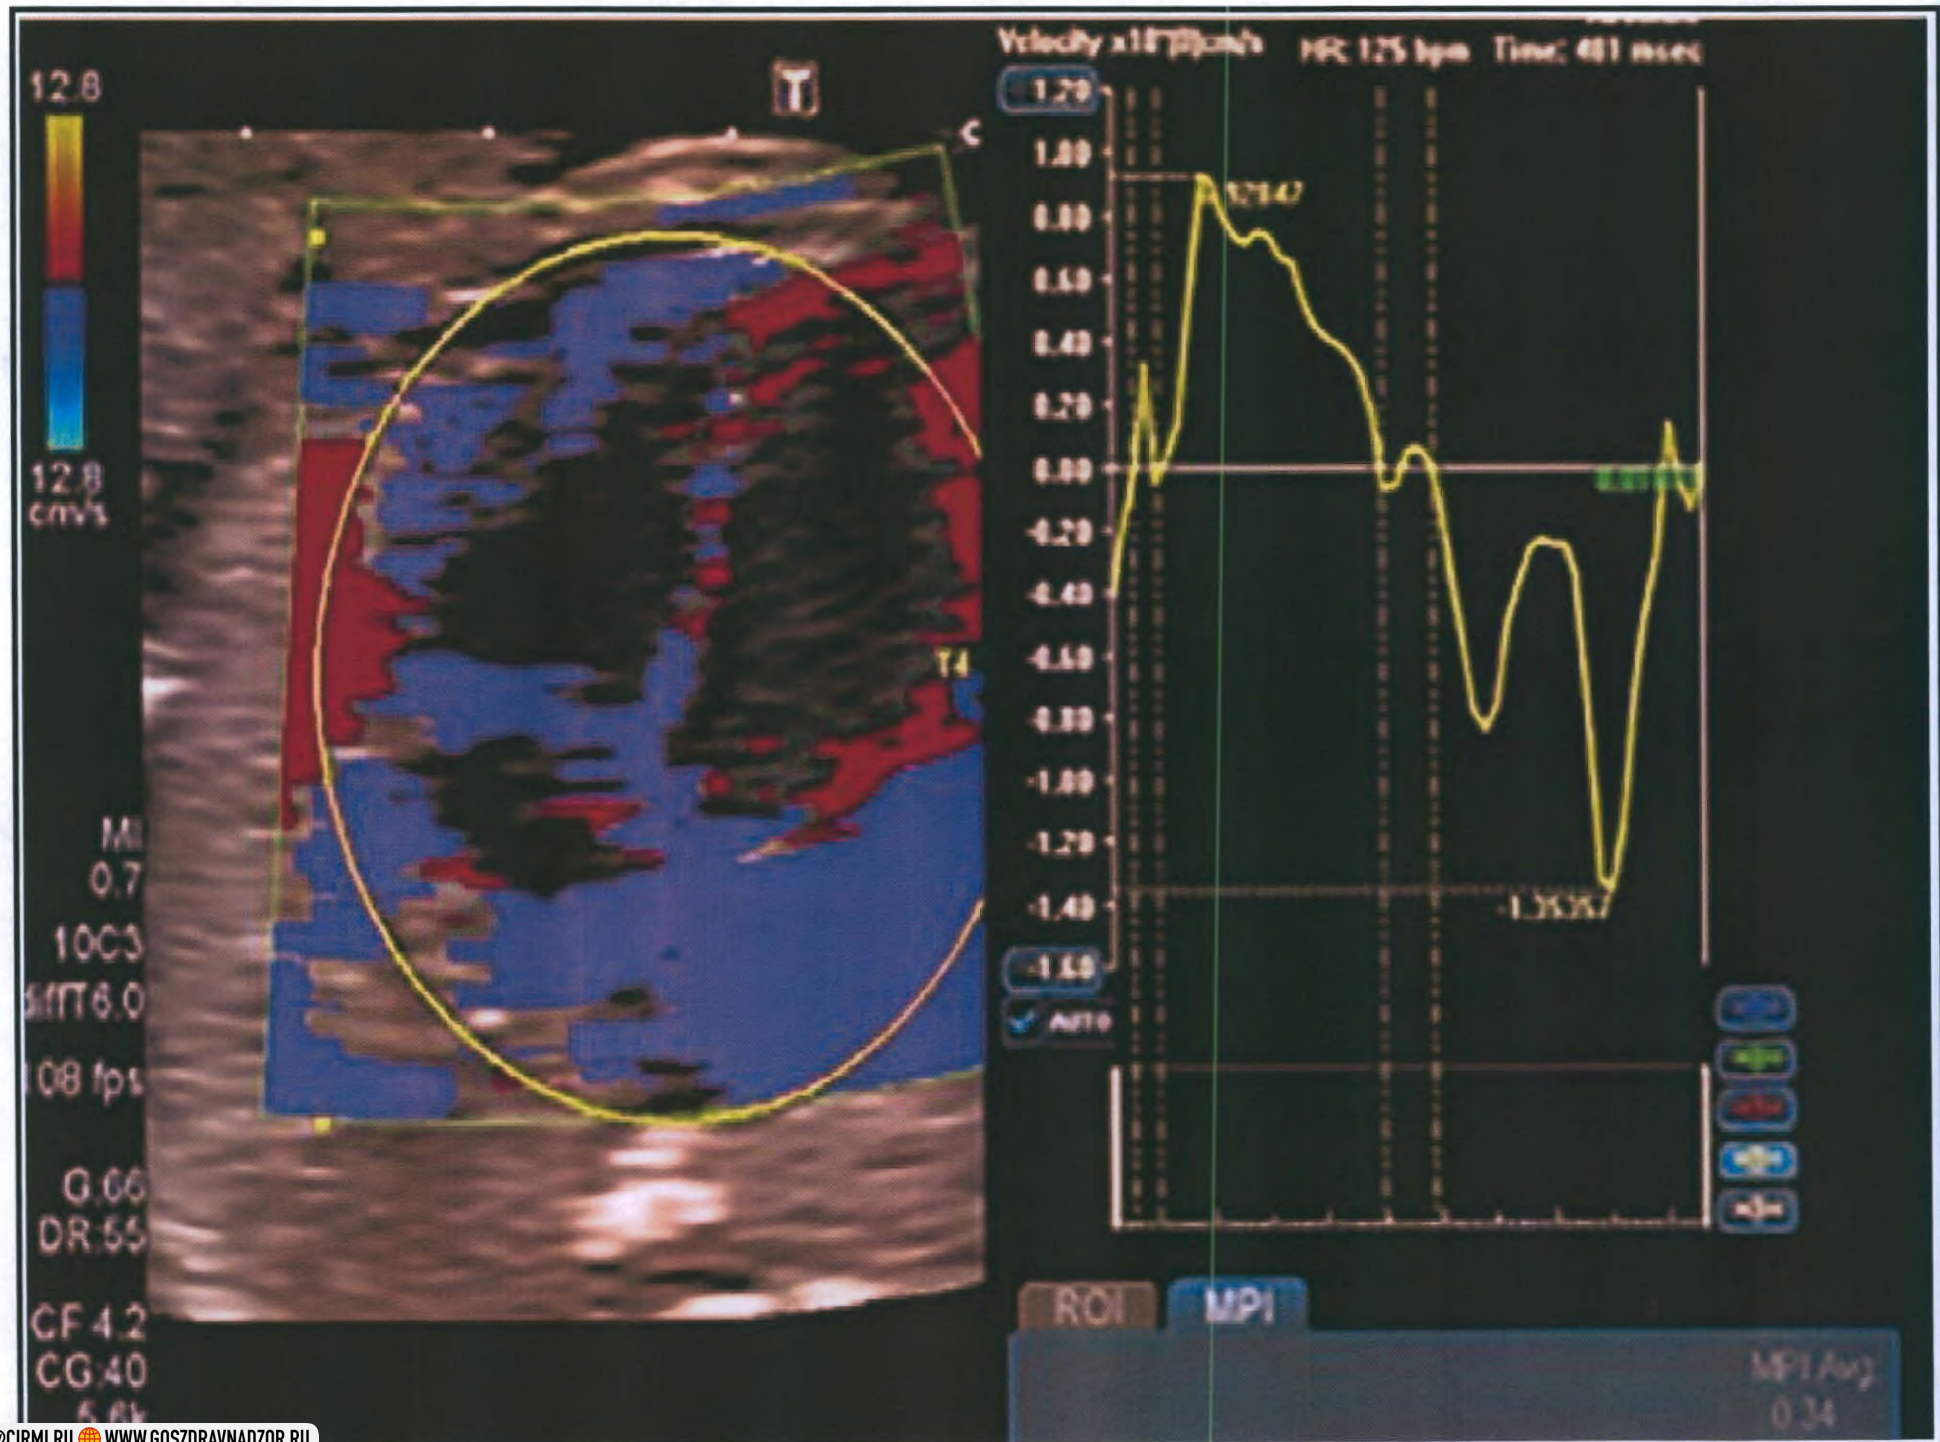




40. Программное приложение для измерения миокардиального индекса сердца плода (Fetal Heart MPI)

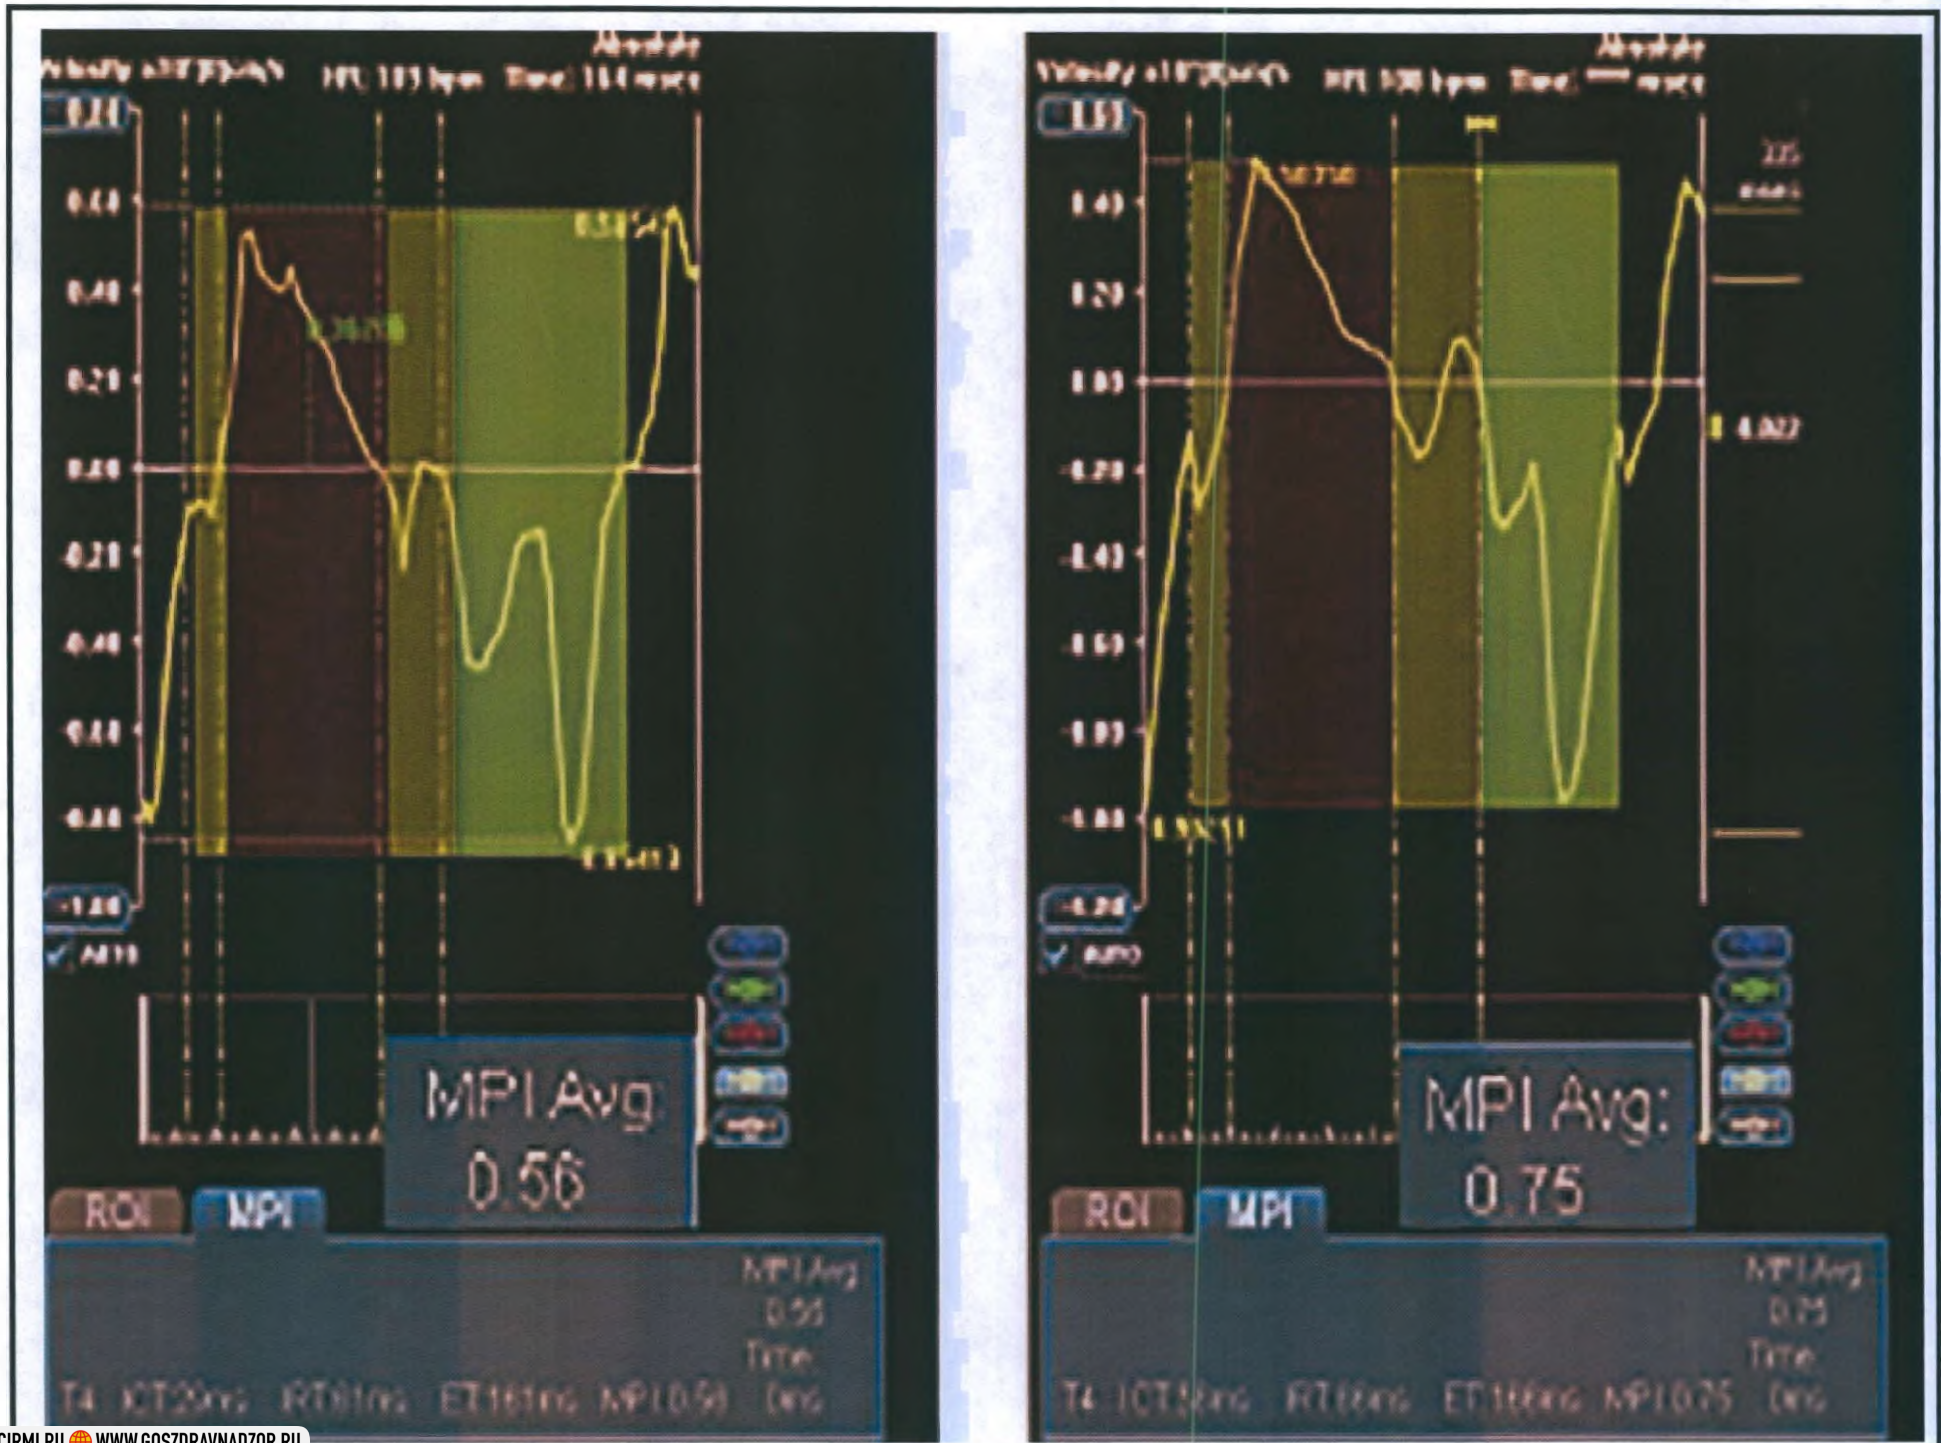



## 41. Программное приложение для измерения Z Score

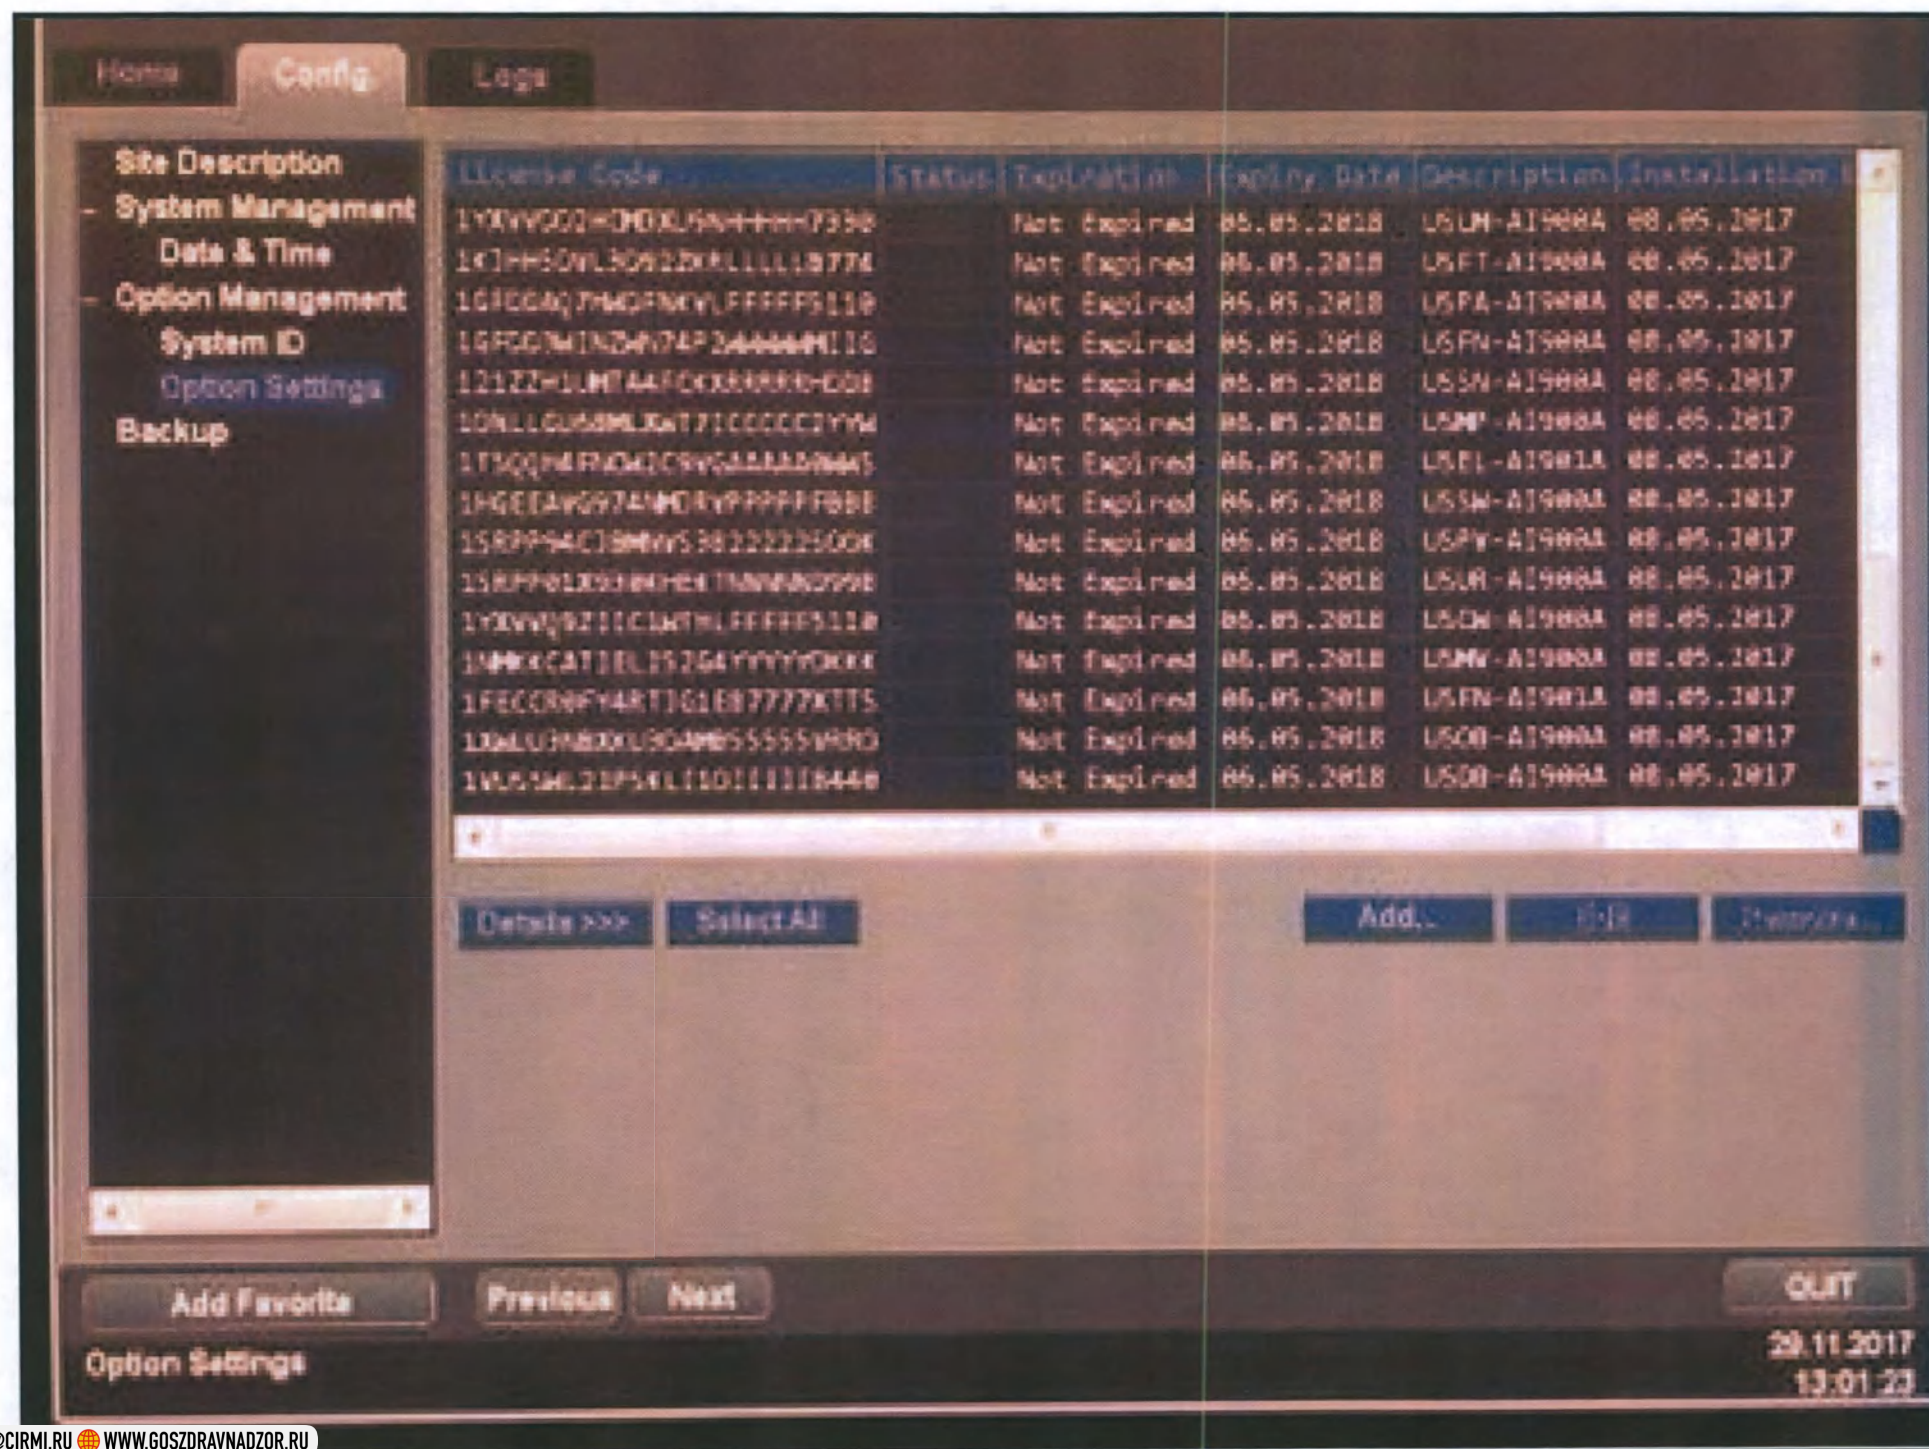



42. Модуль специализированный акушерско-гинекологический (ОВ)

**Наклейка на блок  
системы - 2 шт.**



**Наклейка на  
монитор - 1 шт.**





43. Педаль управления ножная



## 44. Нагреватель геля






## 45. Держатель для кабелей датчиков





46. Держатель для коннекторов датчиков

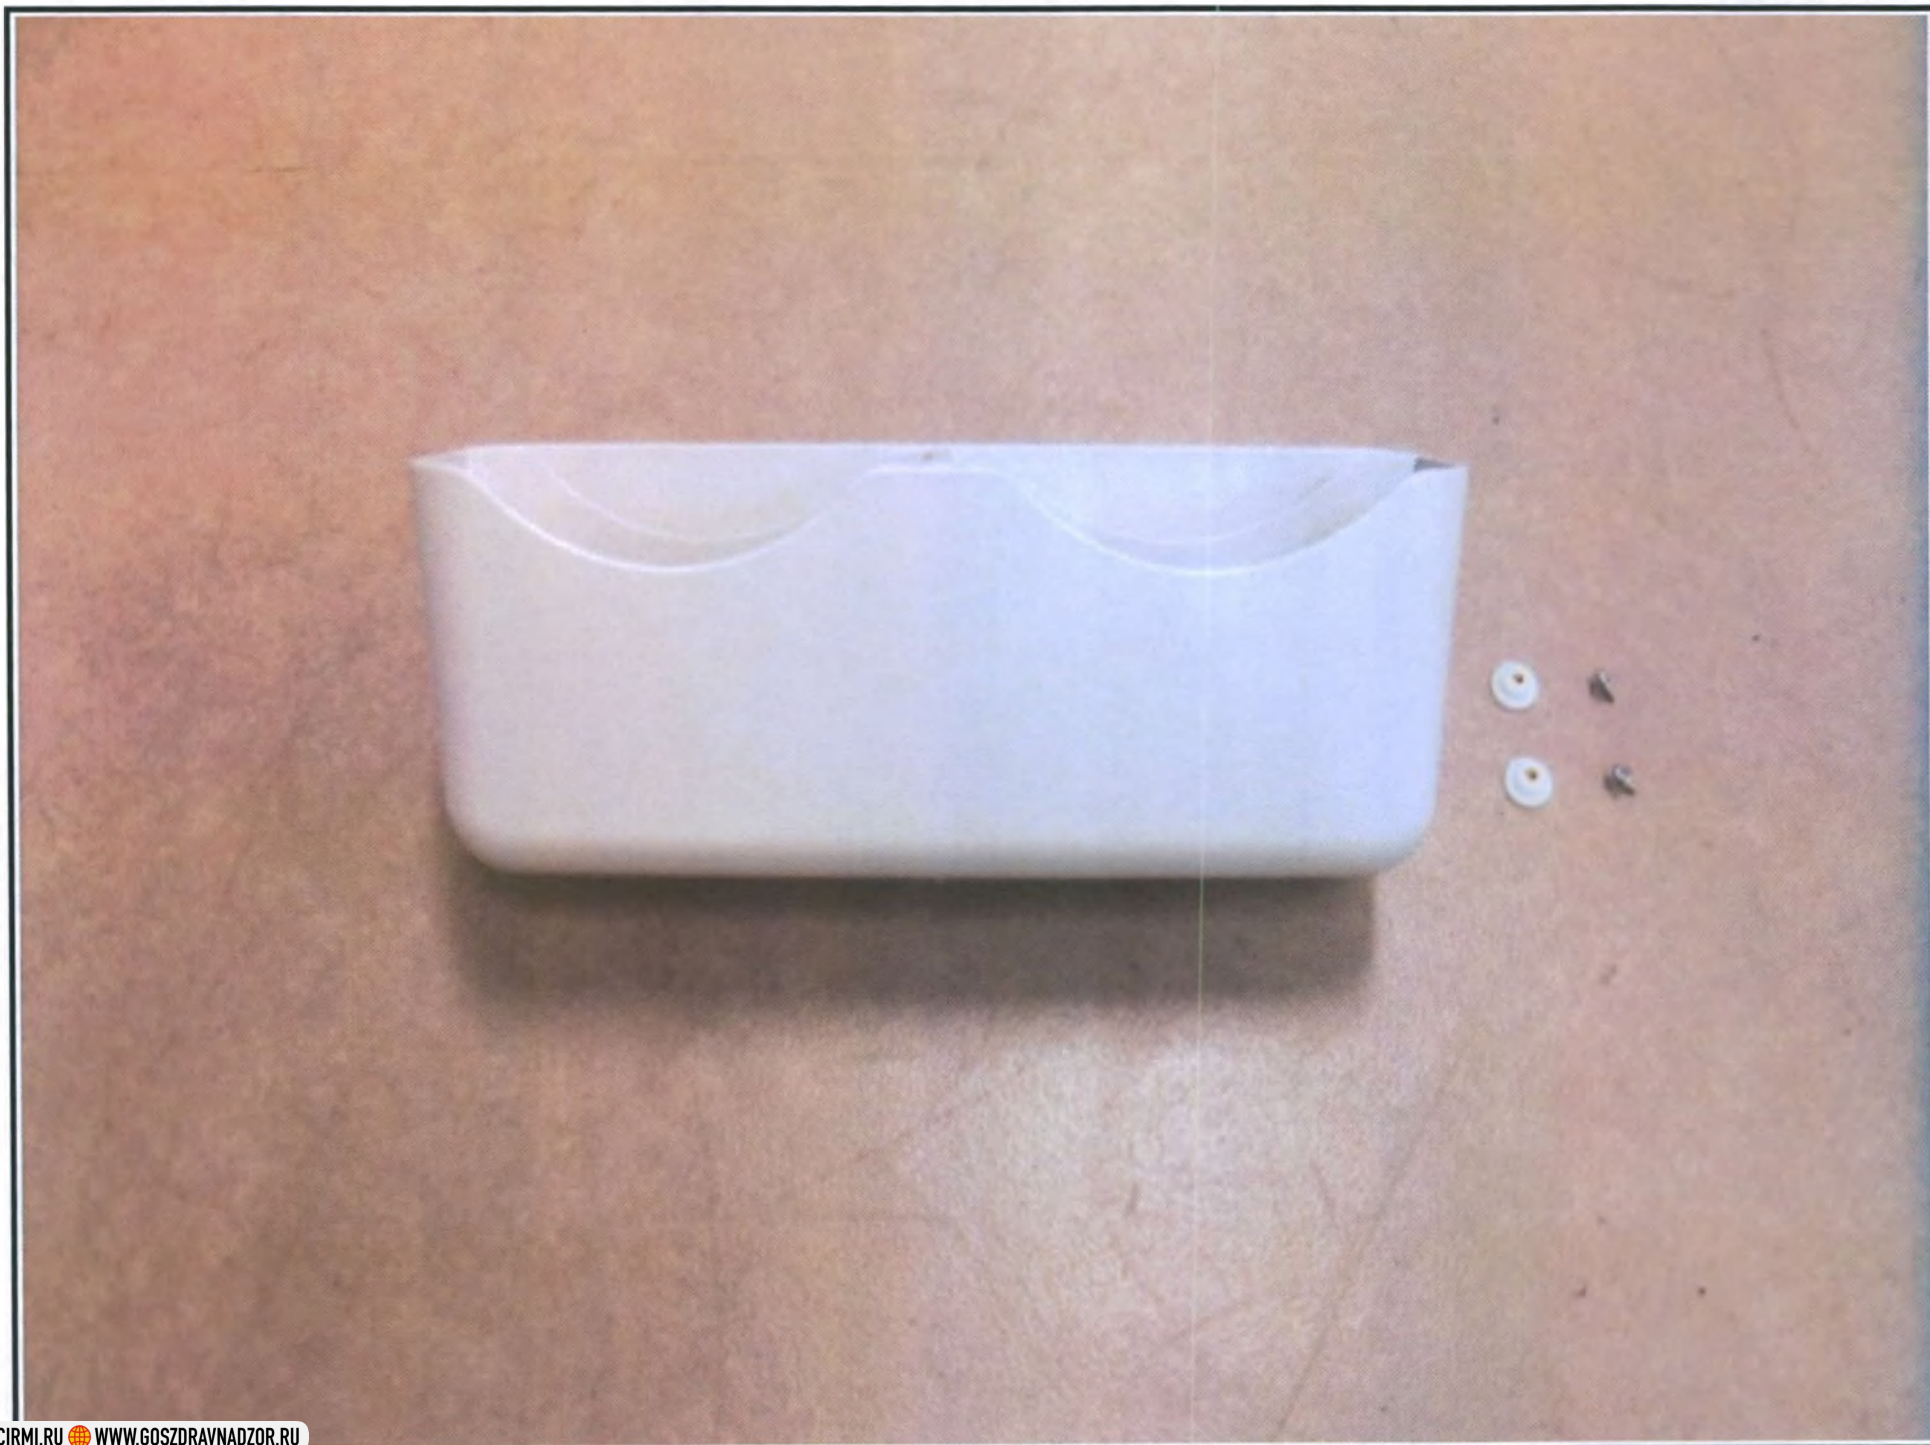



47. Модуль беспроводного подключения к сети DICOM





47. Модуль беспроводного подключения к сети DICOM





48. Держатель для внутриполостного датчика






## 49. Клавиатура дополнительная






## 50. Модуль подключения второй консоли

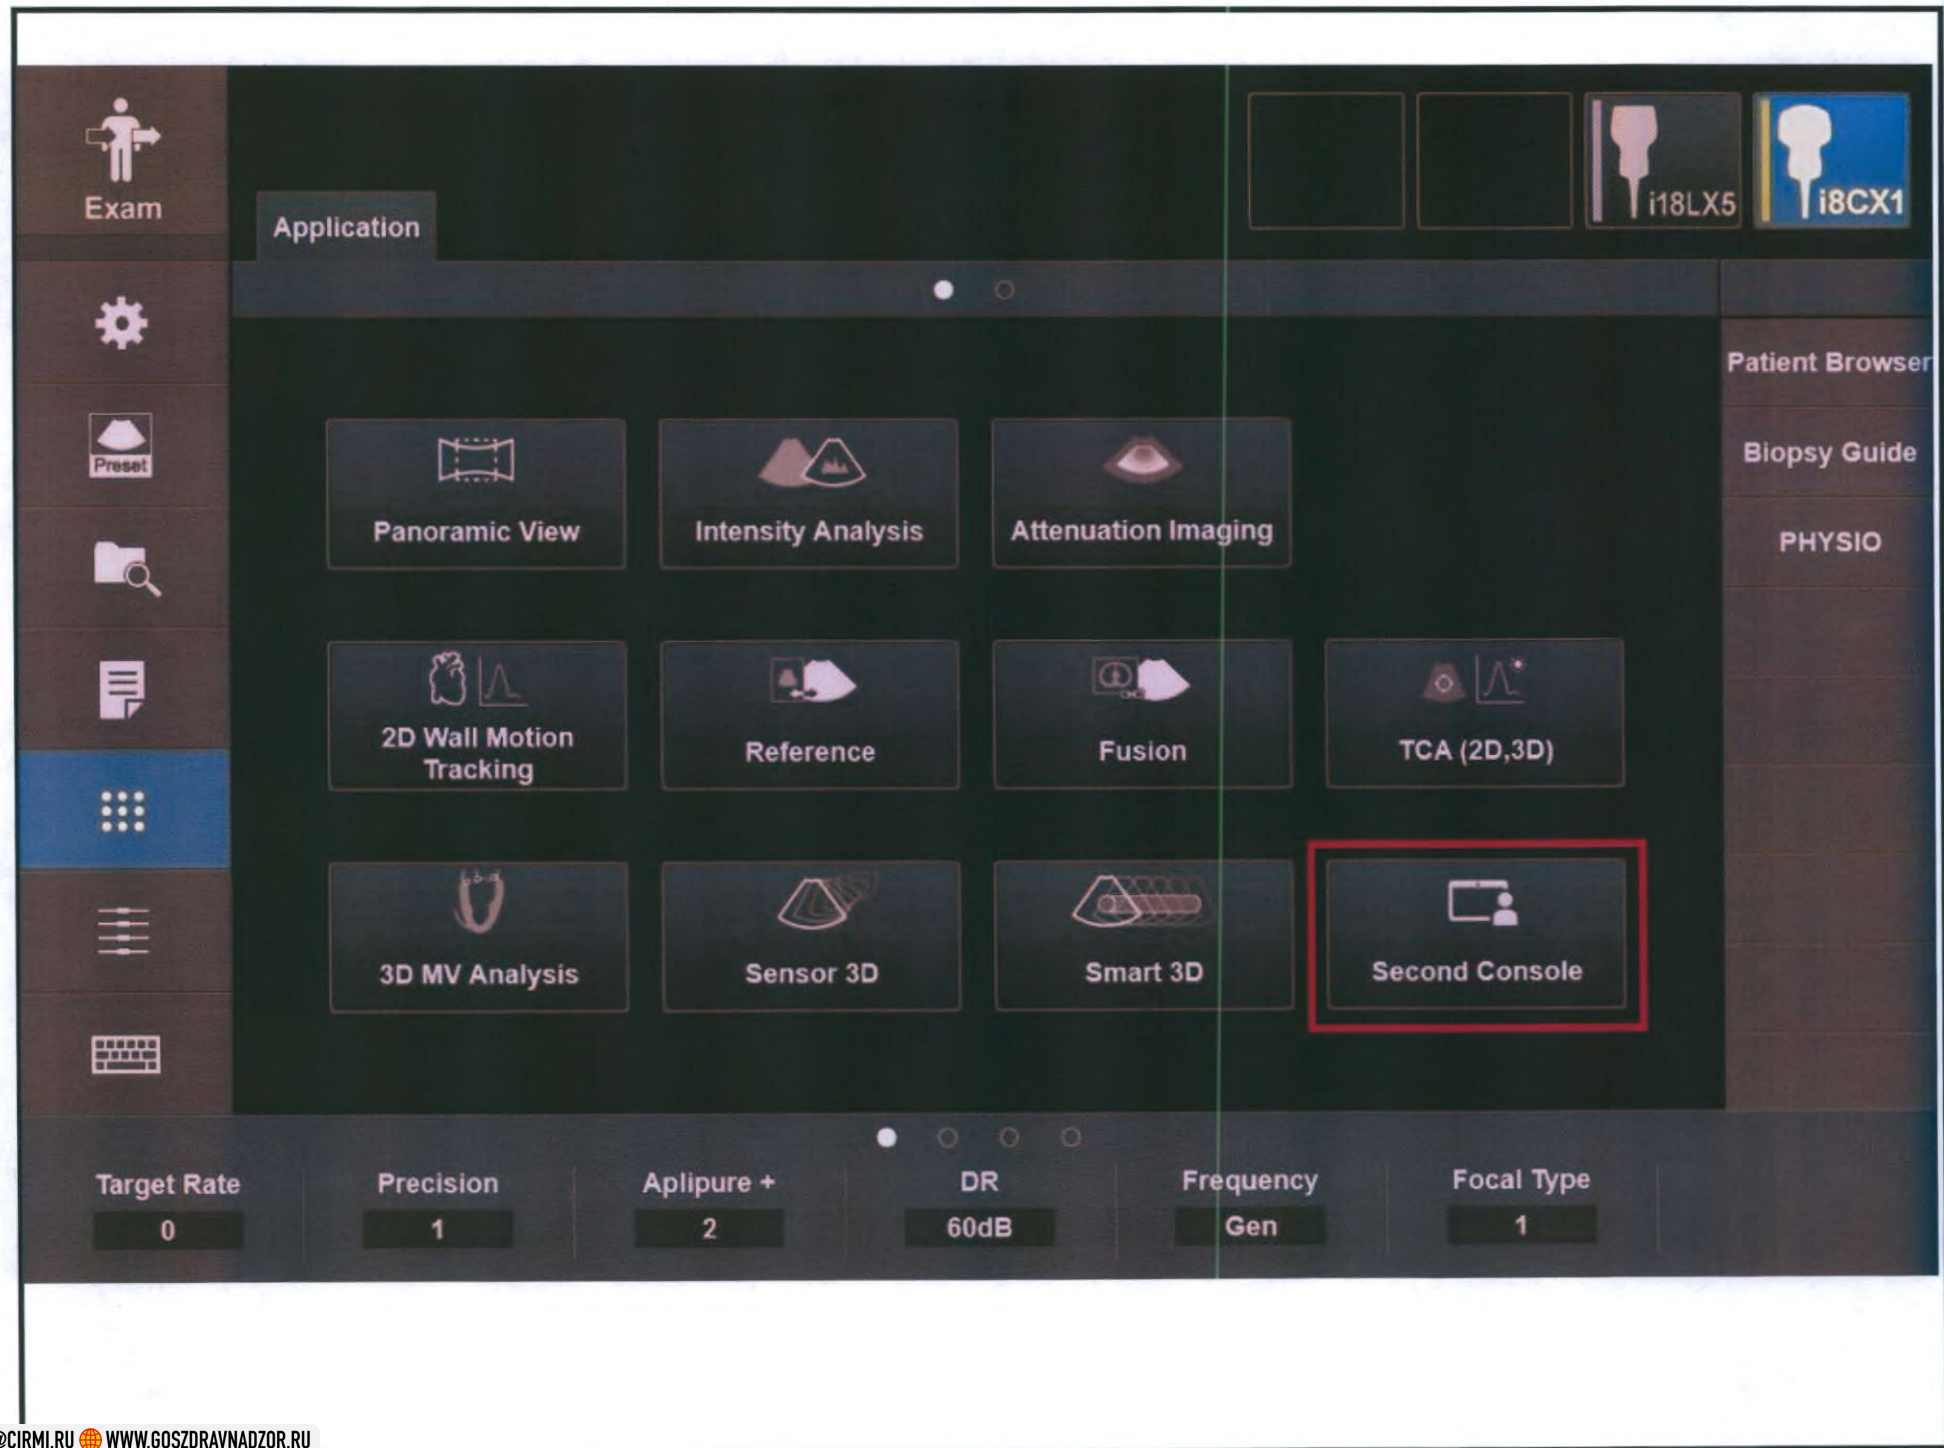




## 50. Модуль подключения второй консоли

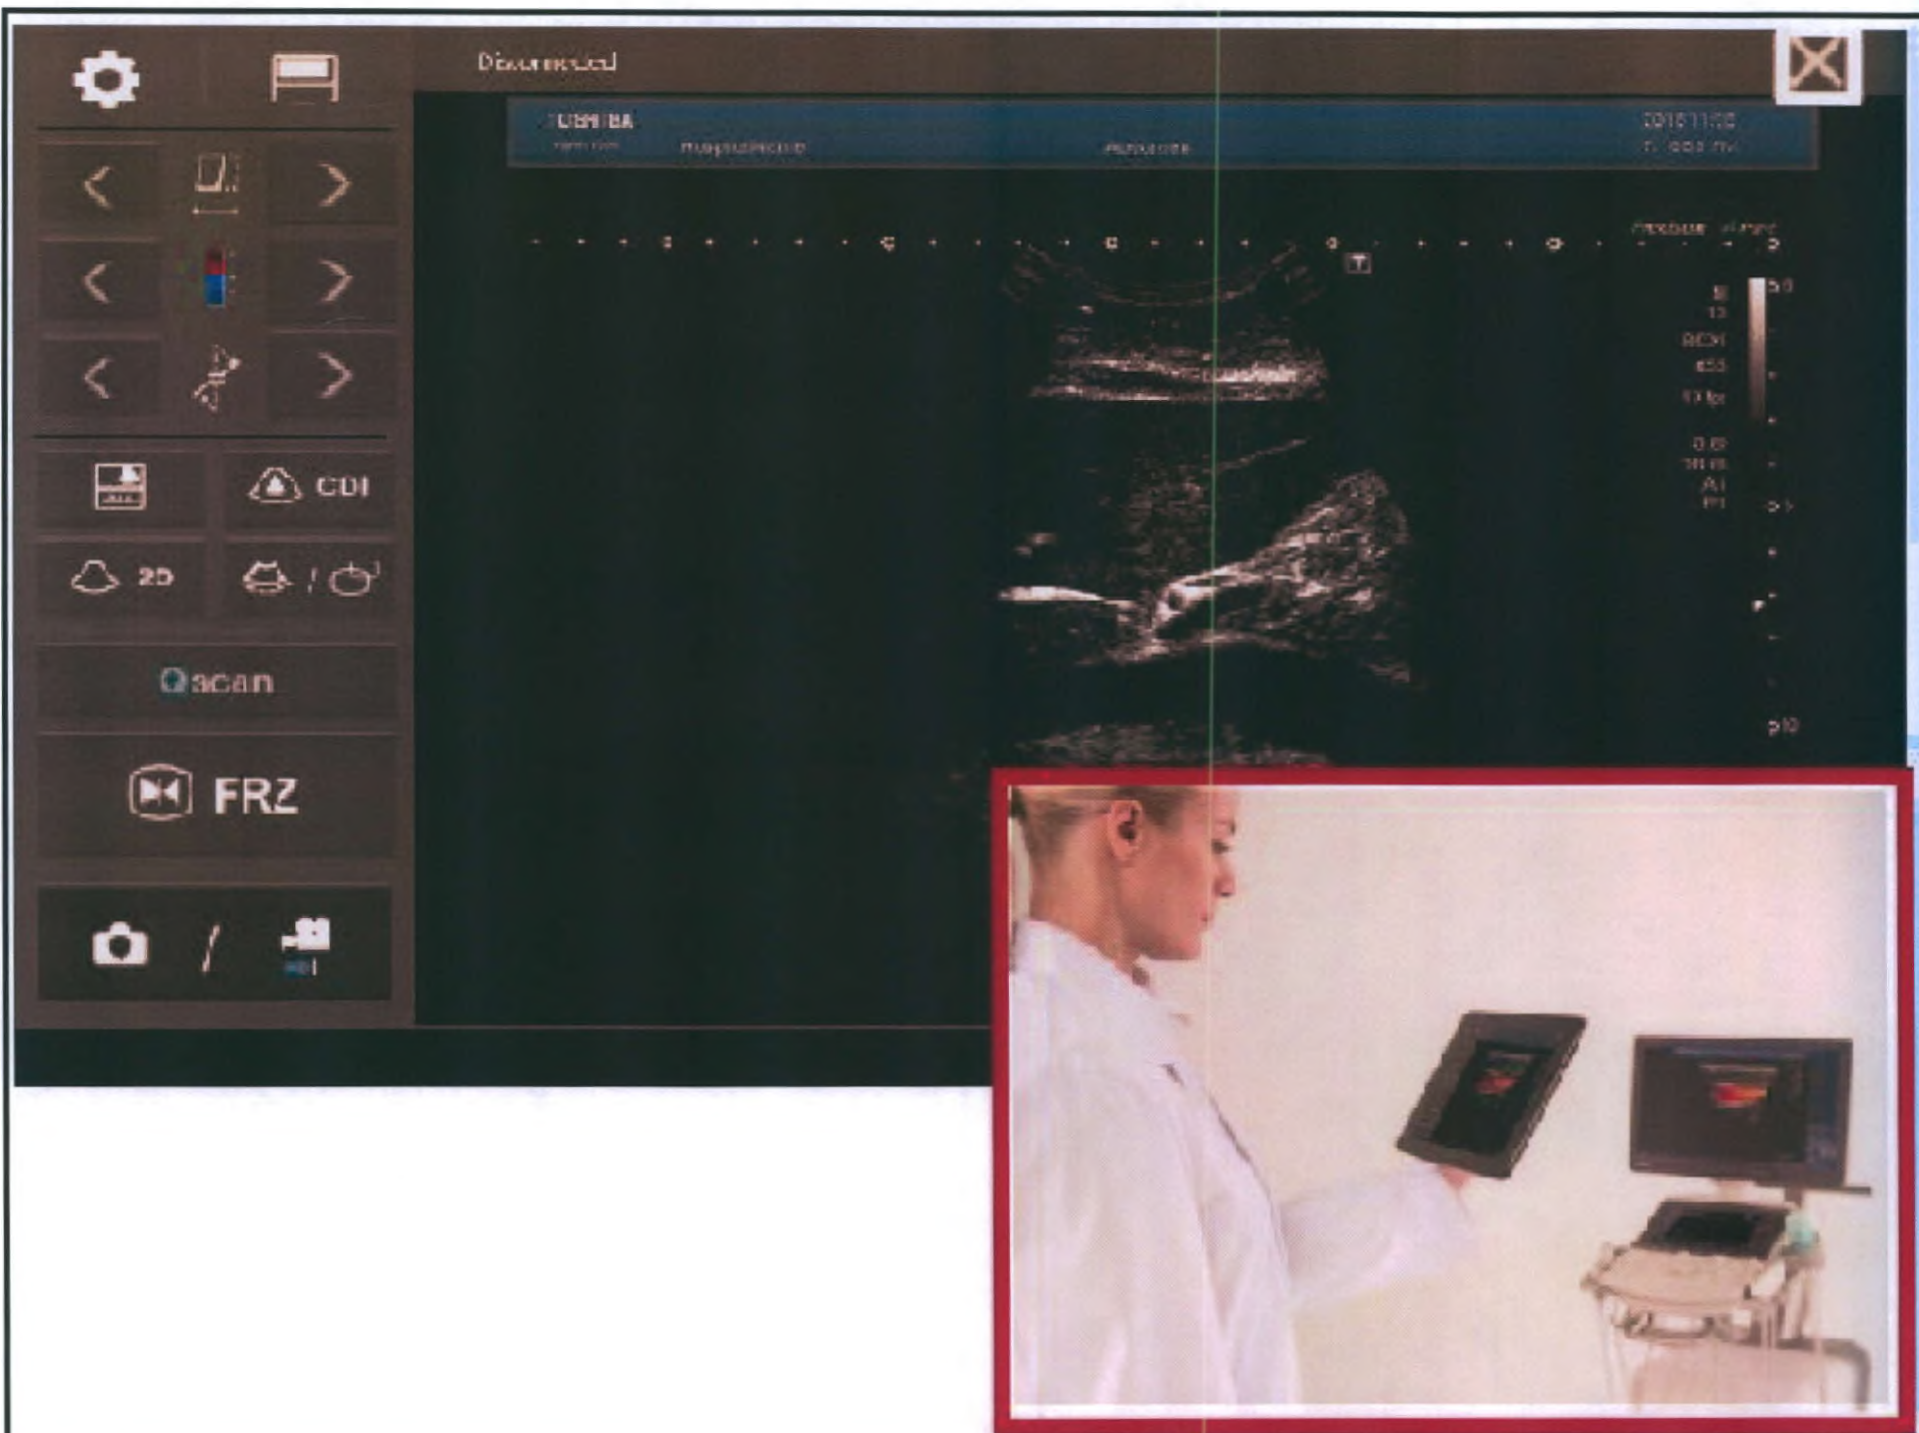




## 50. Модуль подключения второй консоли

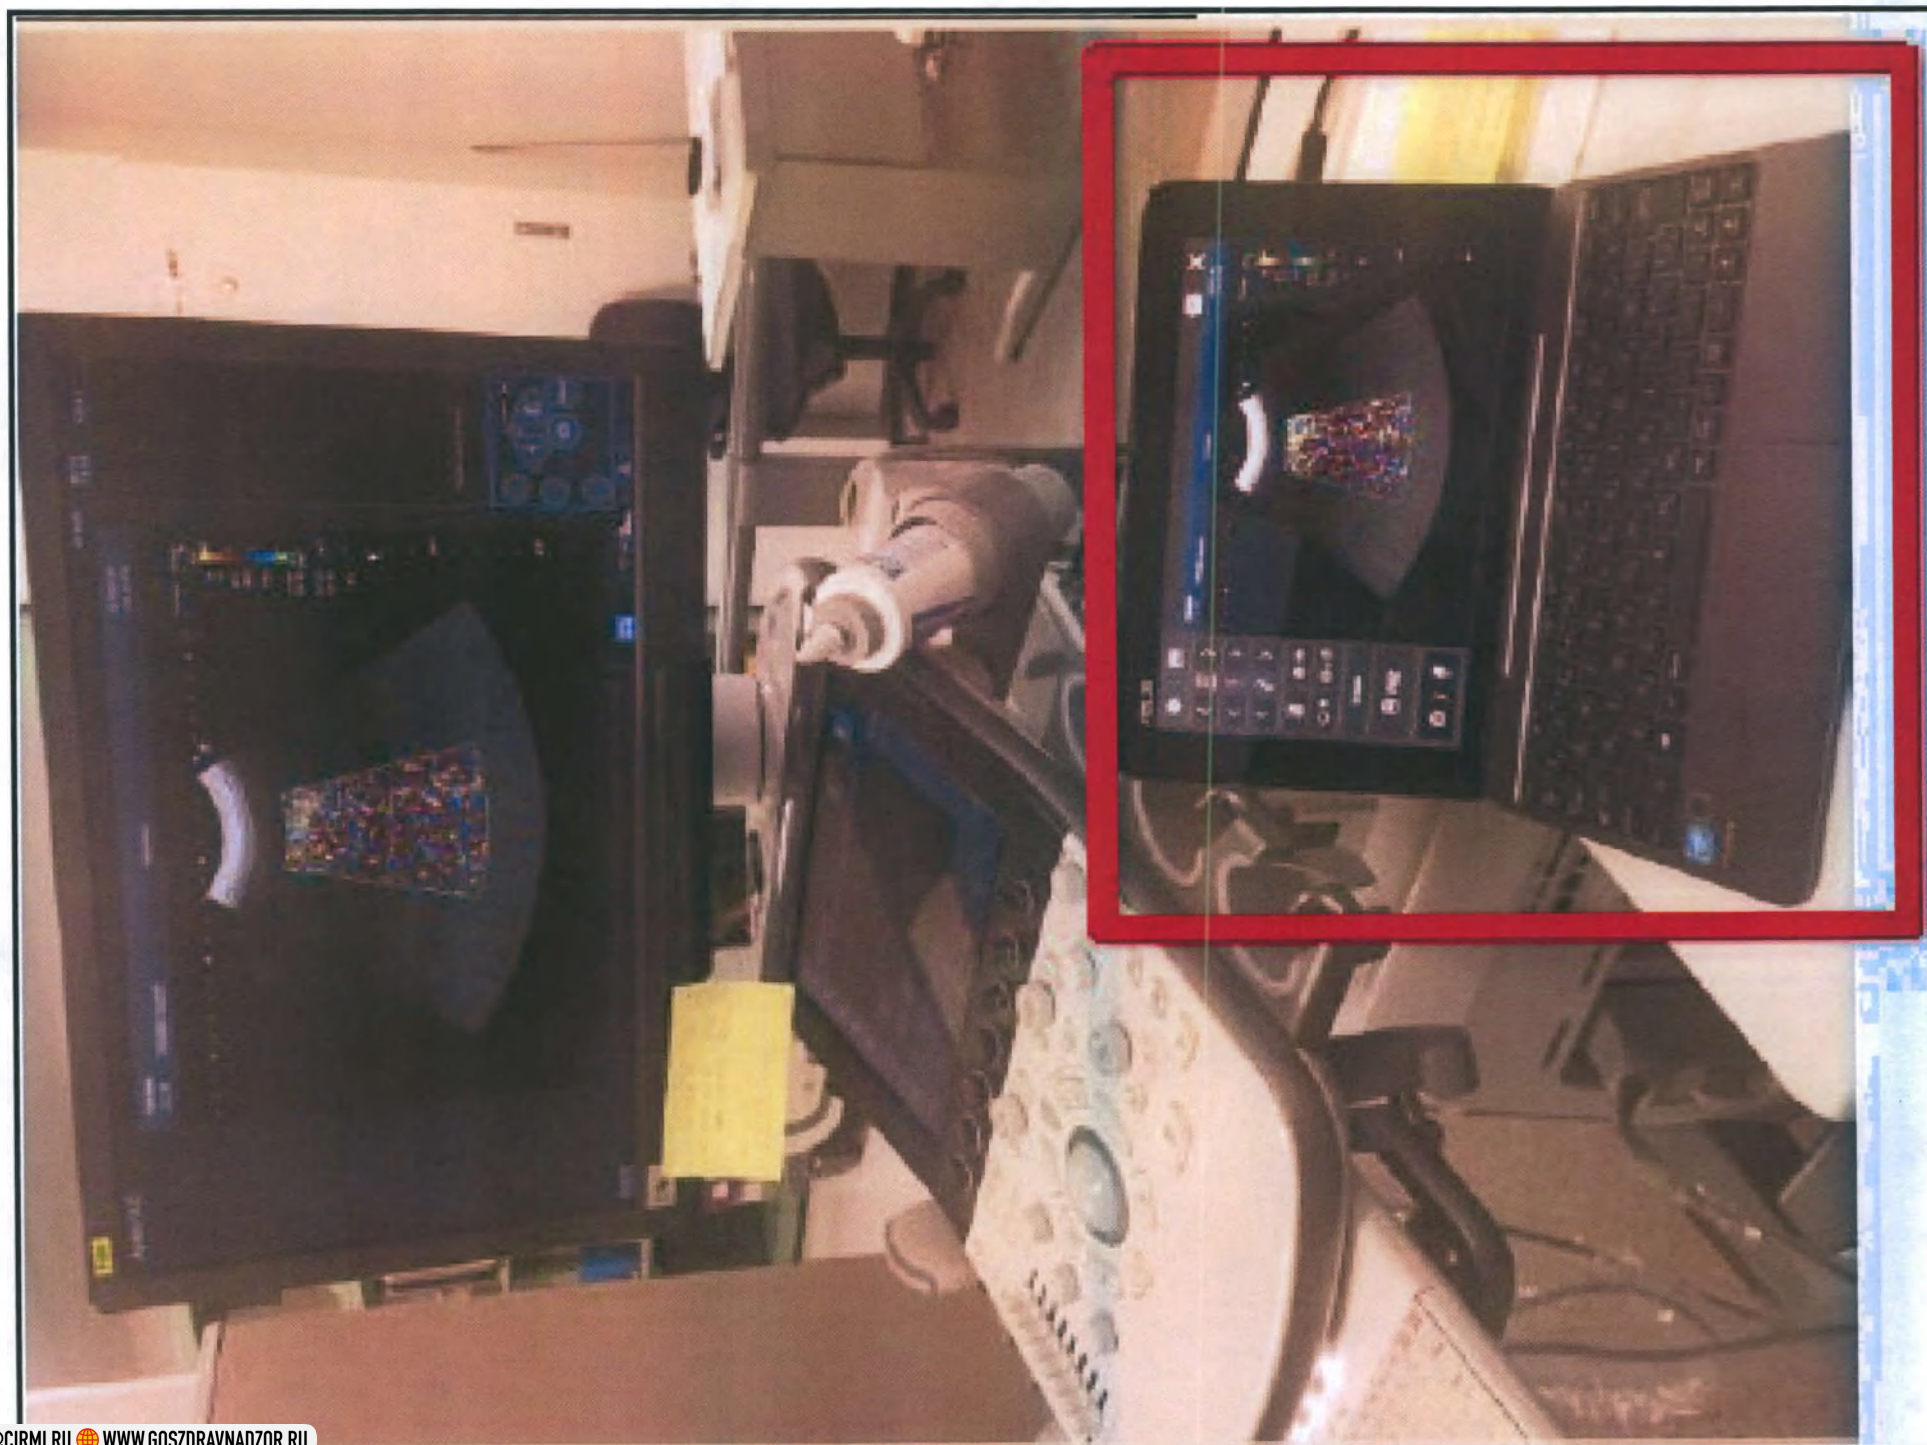



## 51. Программное приложение для поддержки базы данных для внешнего жесткого диска

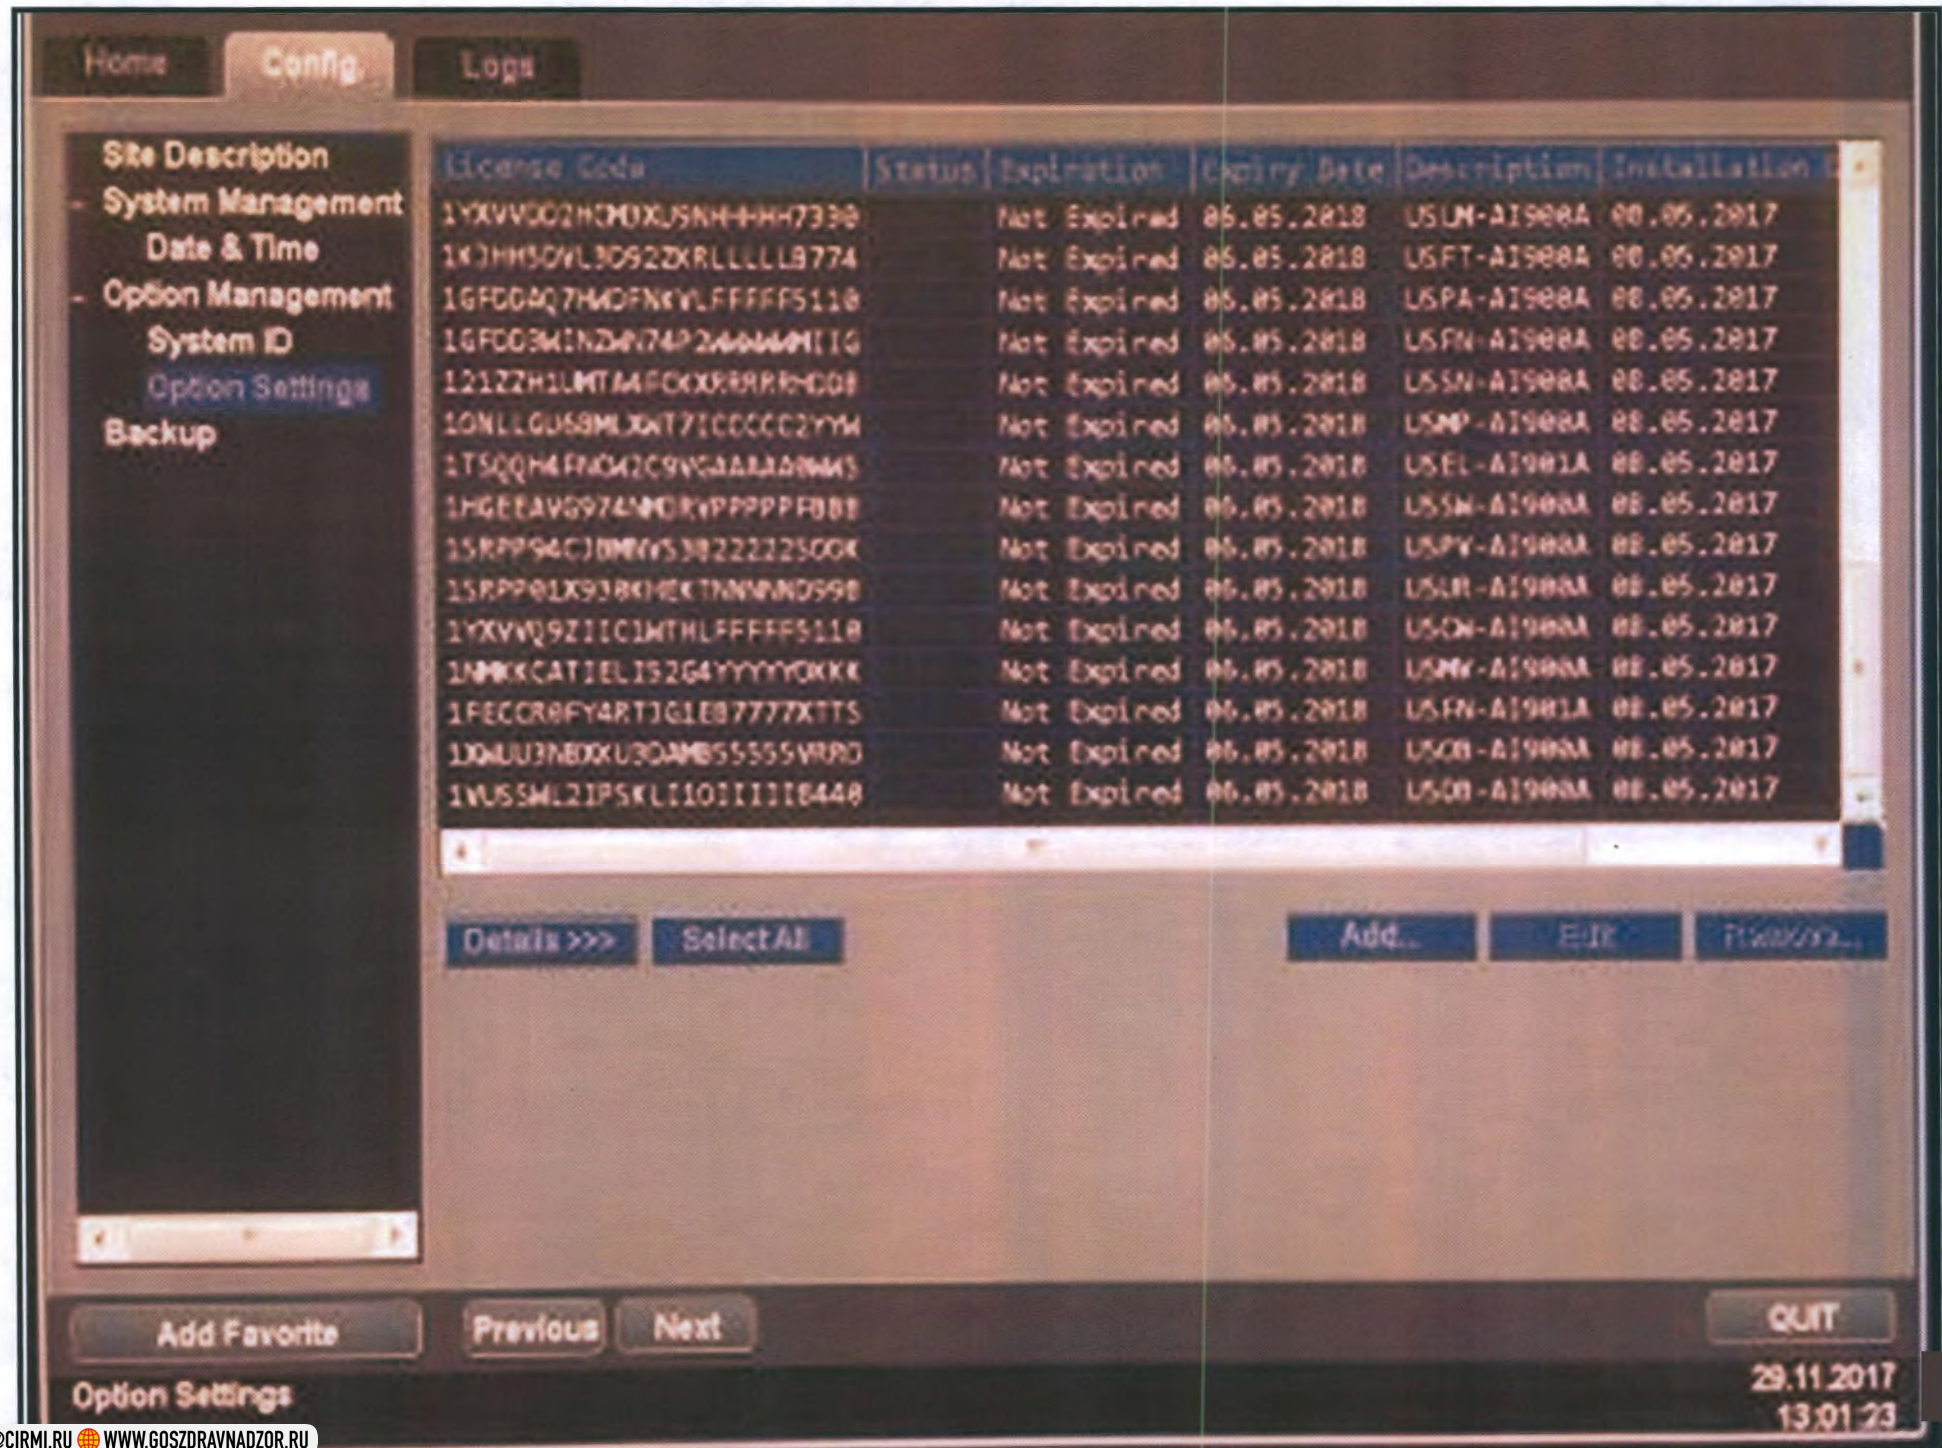




52. Комплект деталей для монтажа внешнего жесткого диска






52. Комплект деталей для монтажа внешнего жесткого диска

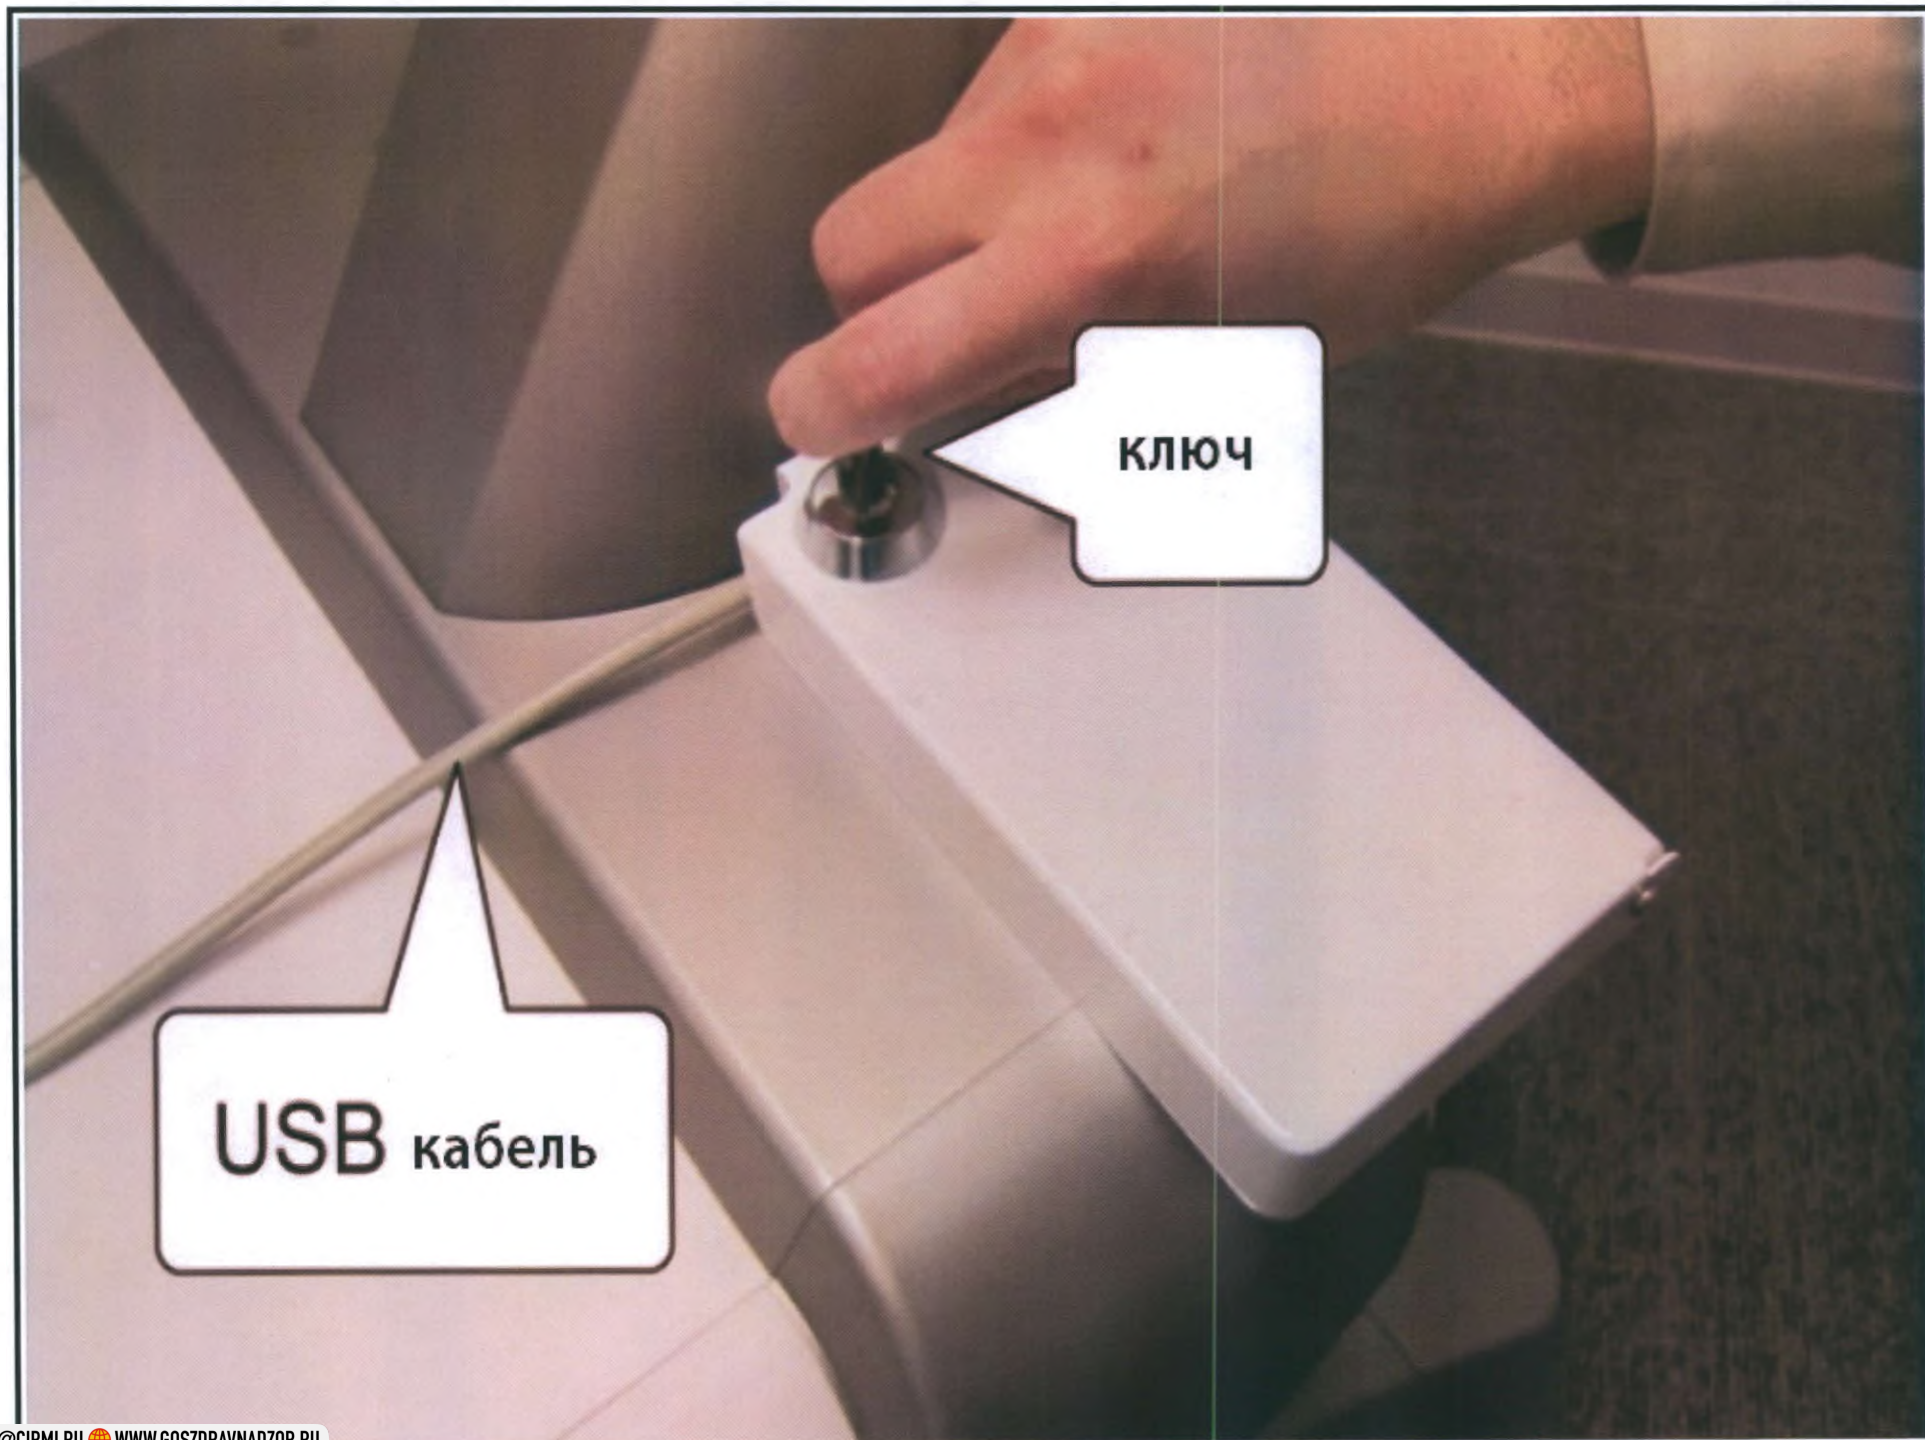



## 53. Держатель для кабеля ЭКГ

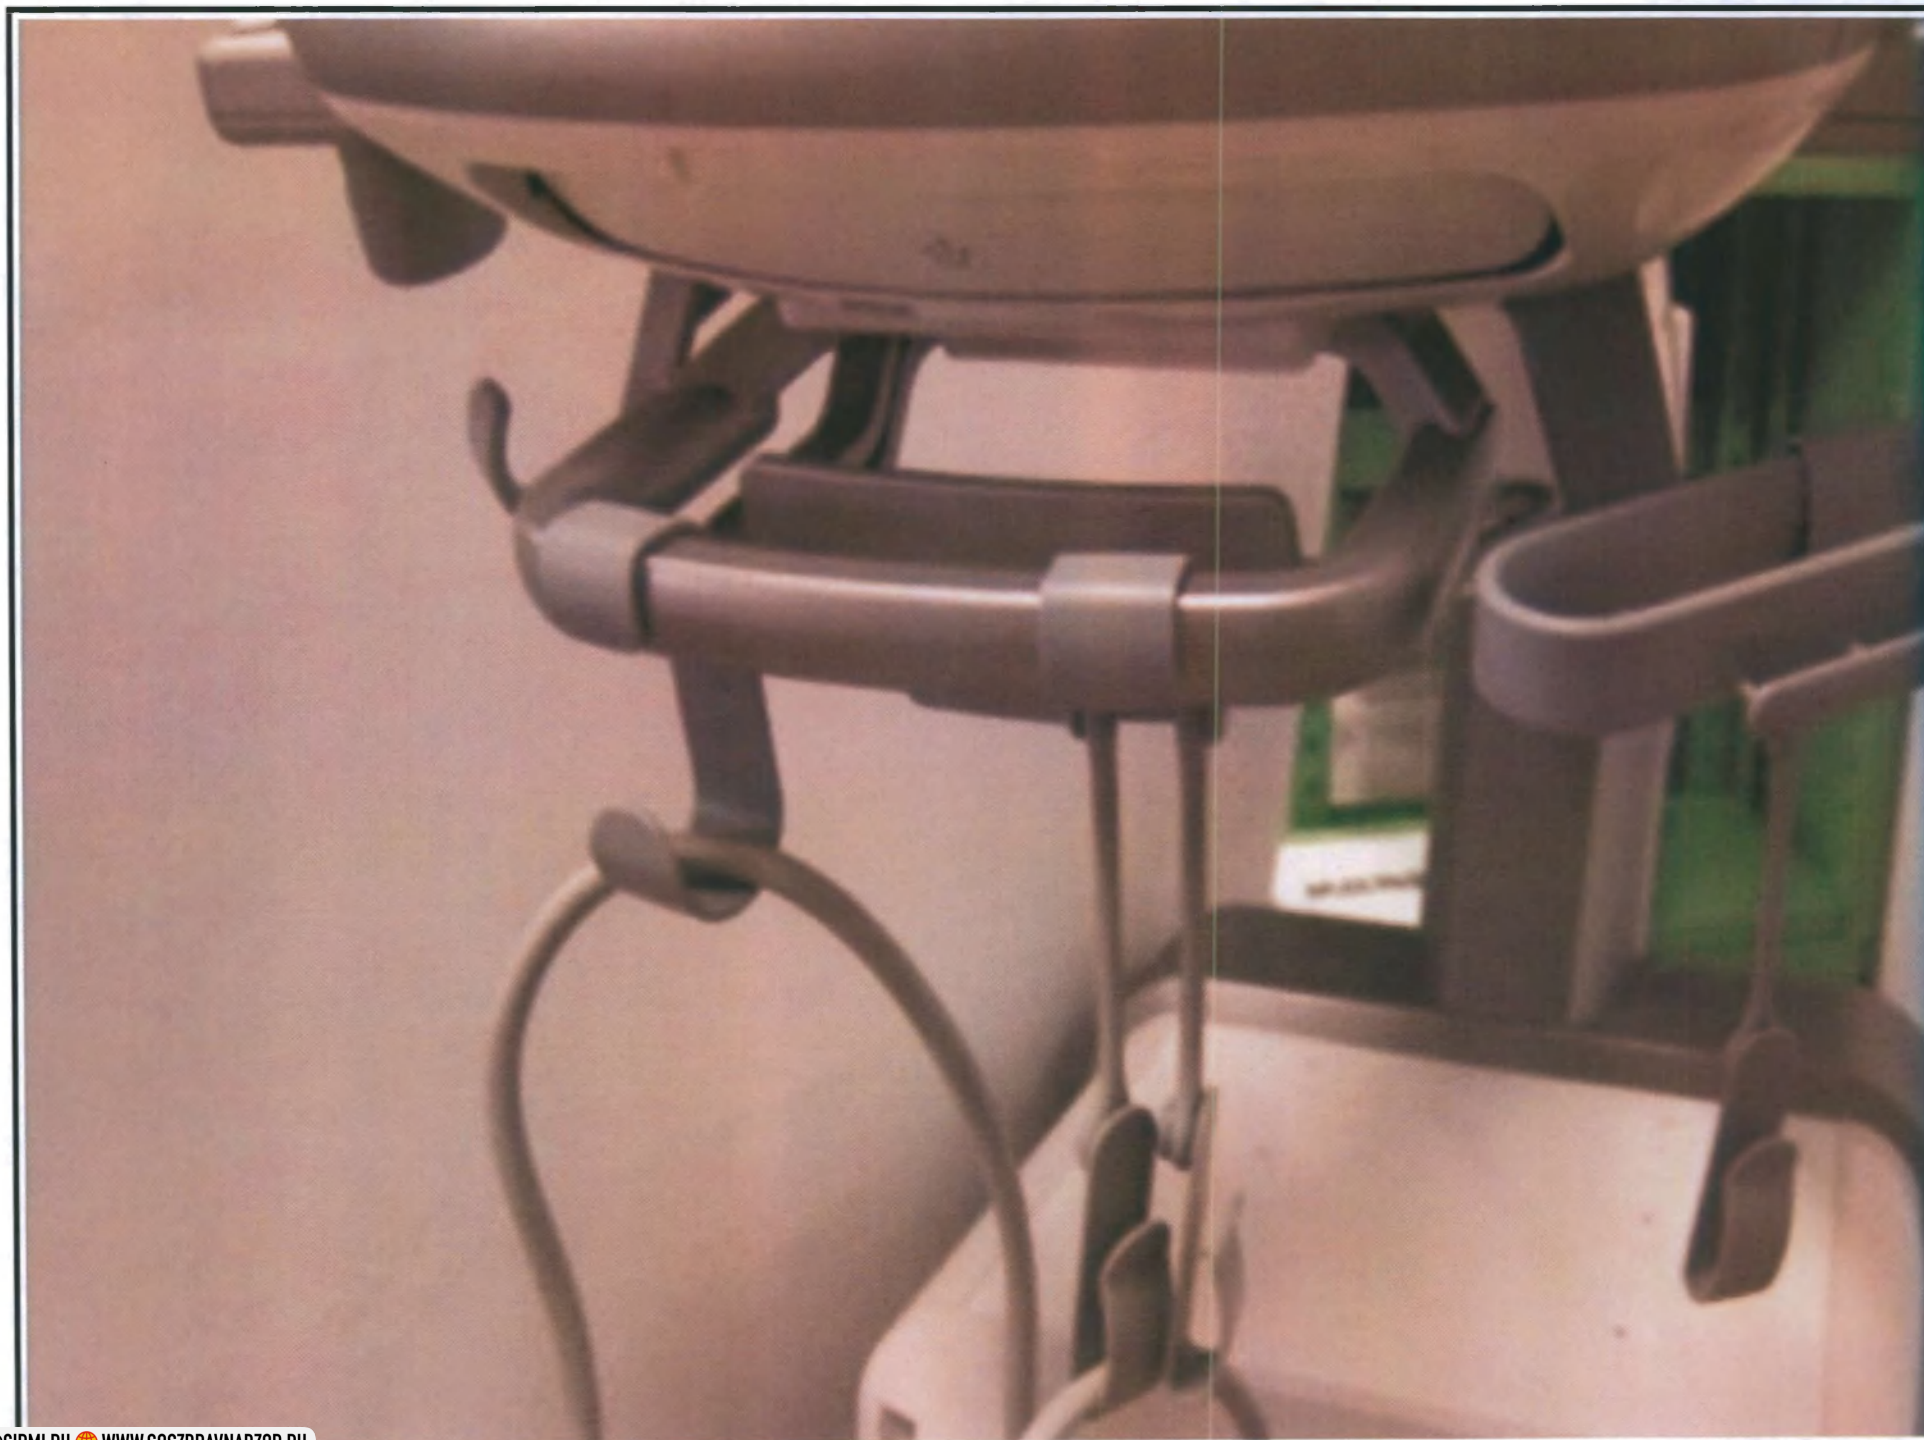



## 54. Модуль панели с USB-портом






## 55. Комплект батарей





## 56. Программное приложение для интерактивной справки

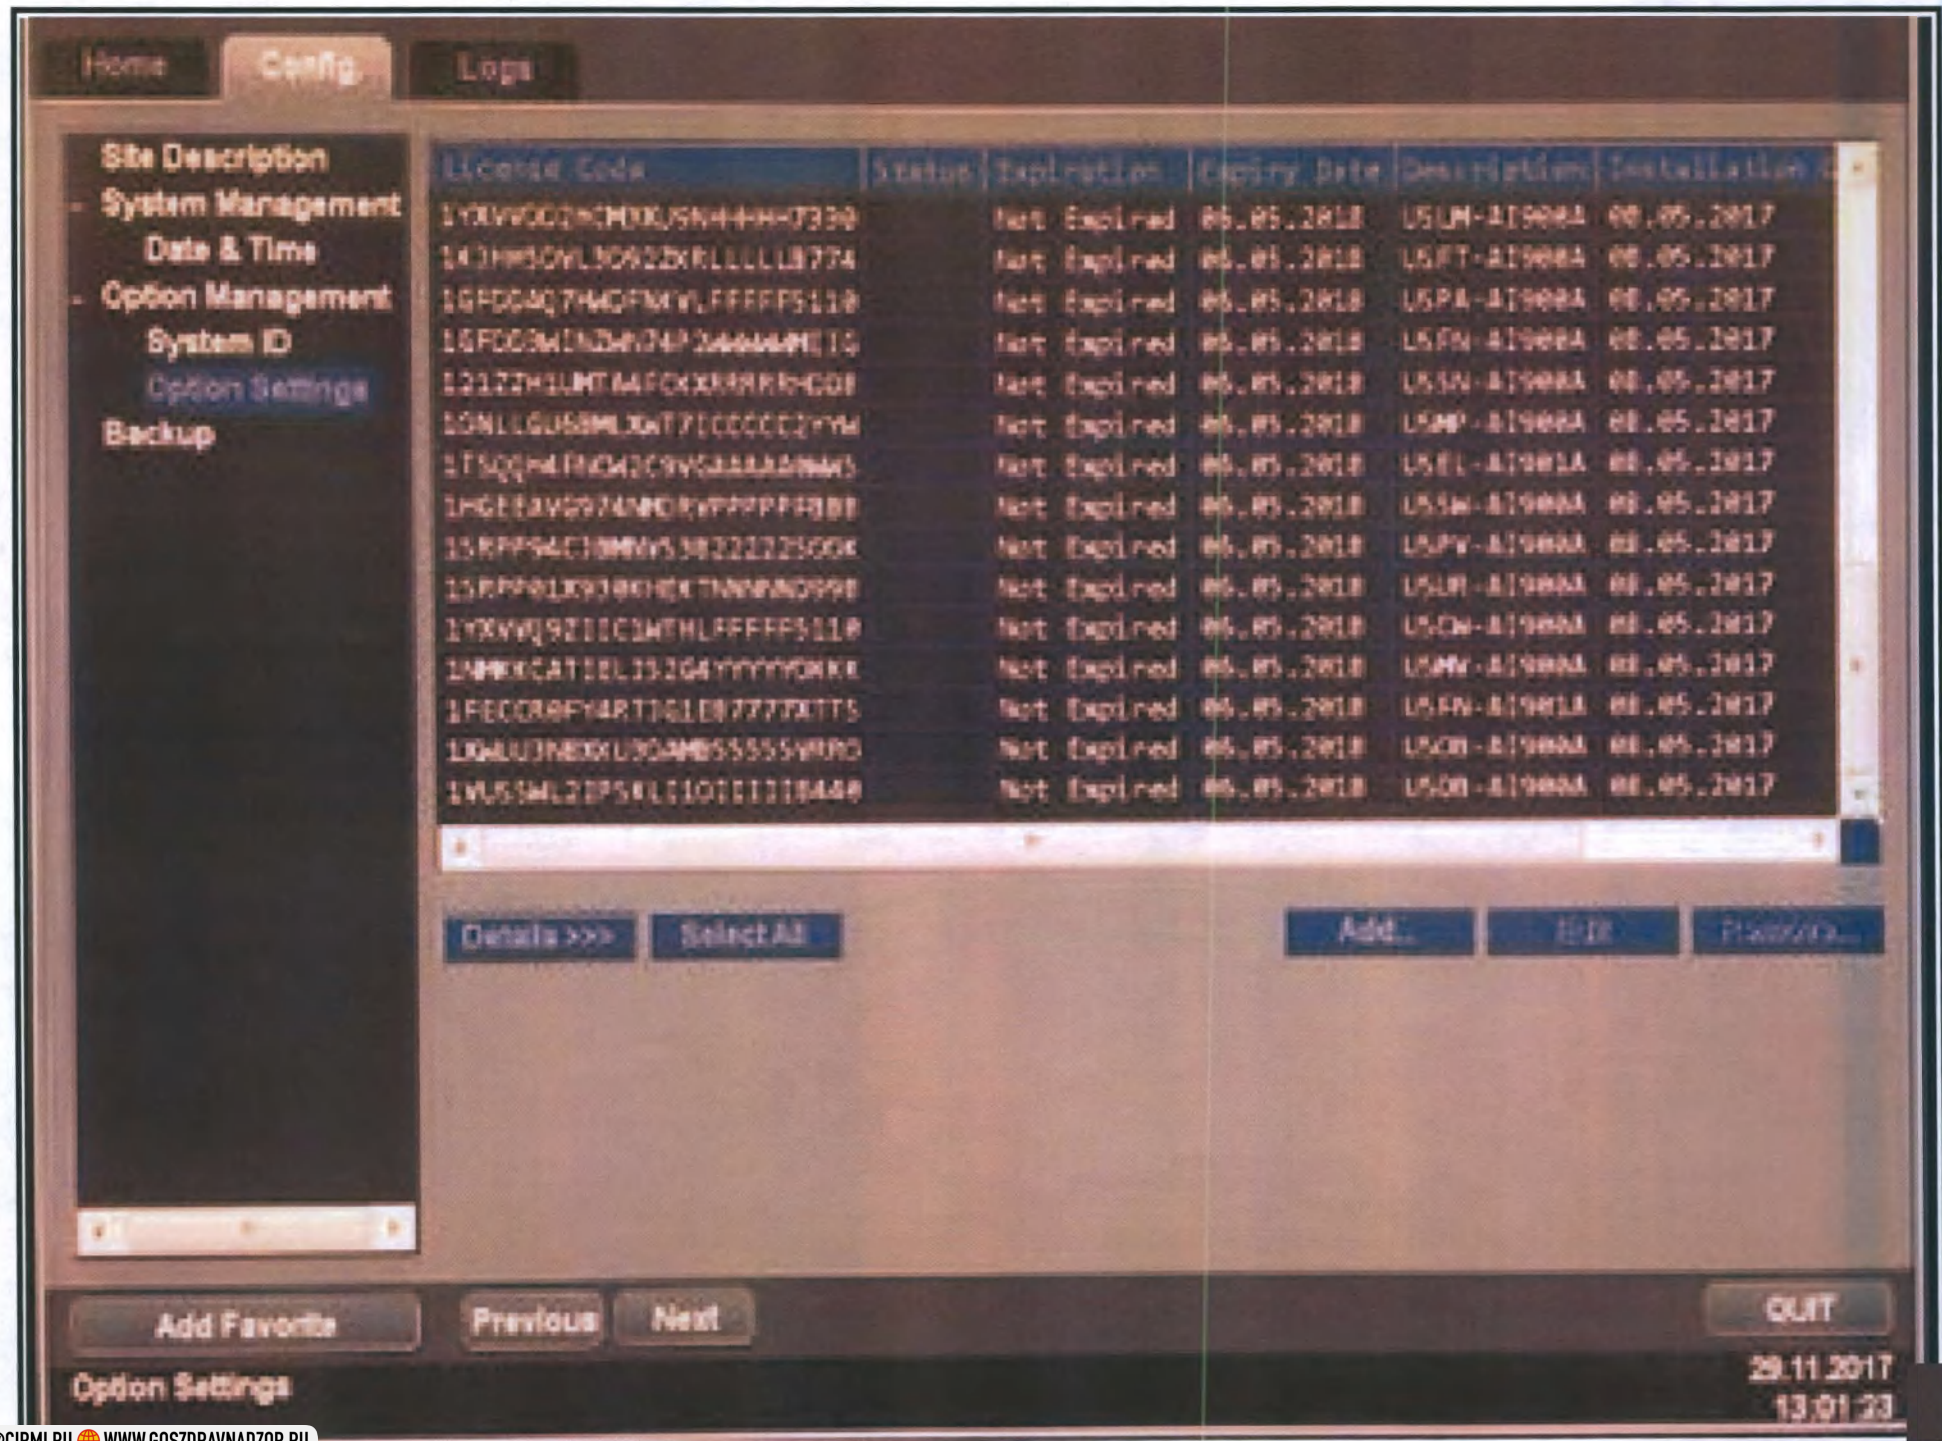









## 58. Программное приложение для референсного изображения

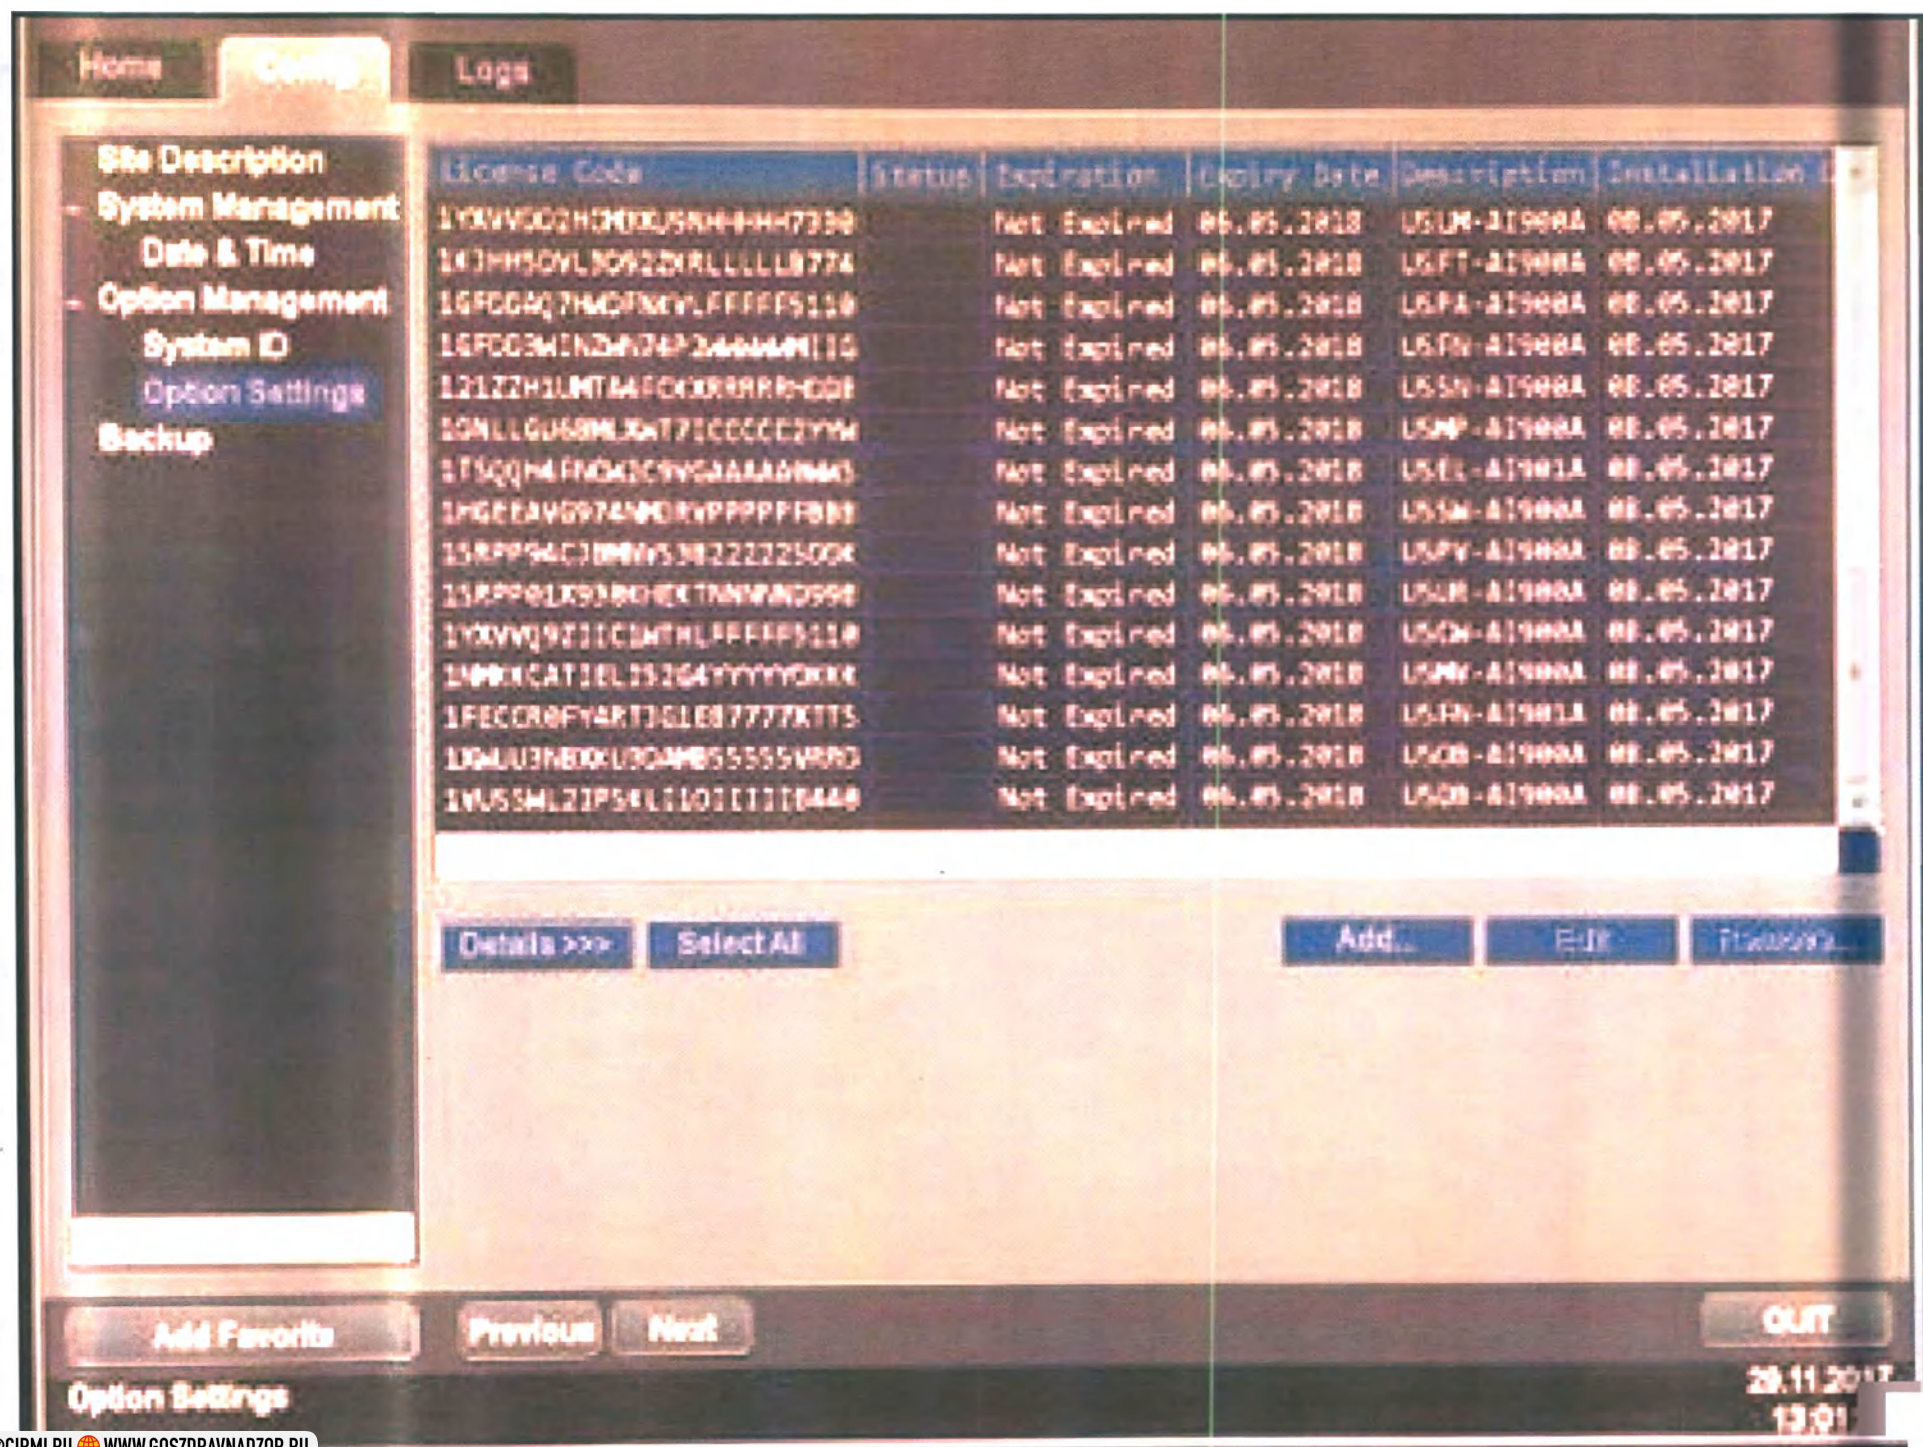



## 59. Программное приложение для обеспечения безопасности системы (Security Management)

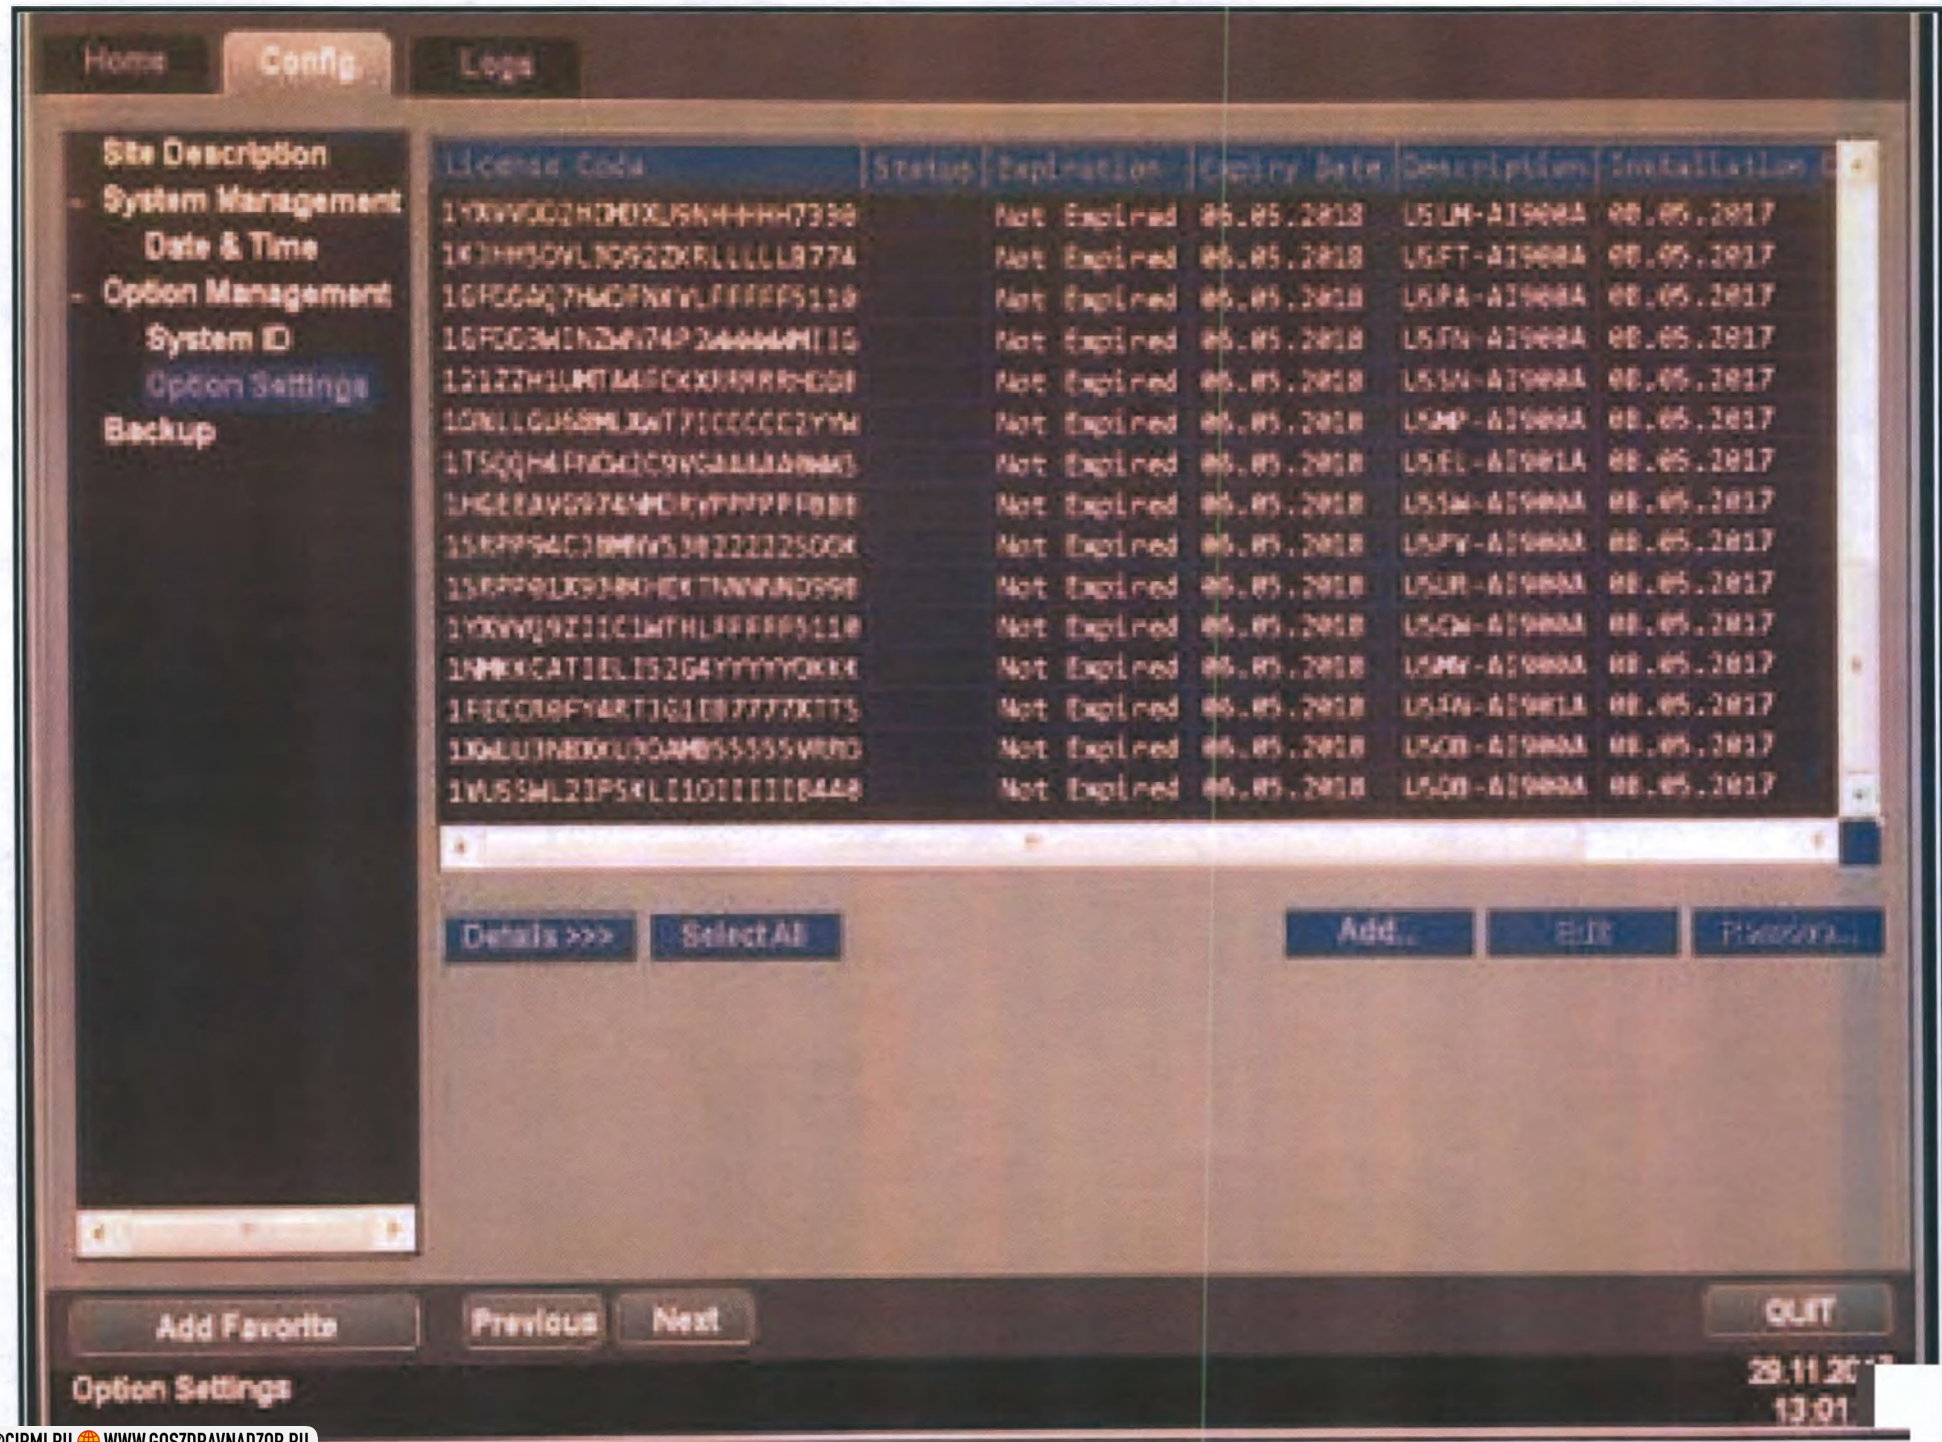




## 60. Модуль регулировки наклона панели





## 60. Модуль регулировки наклона панели

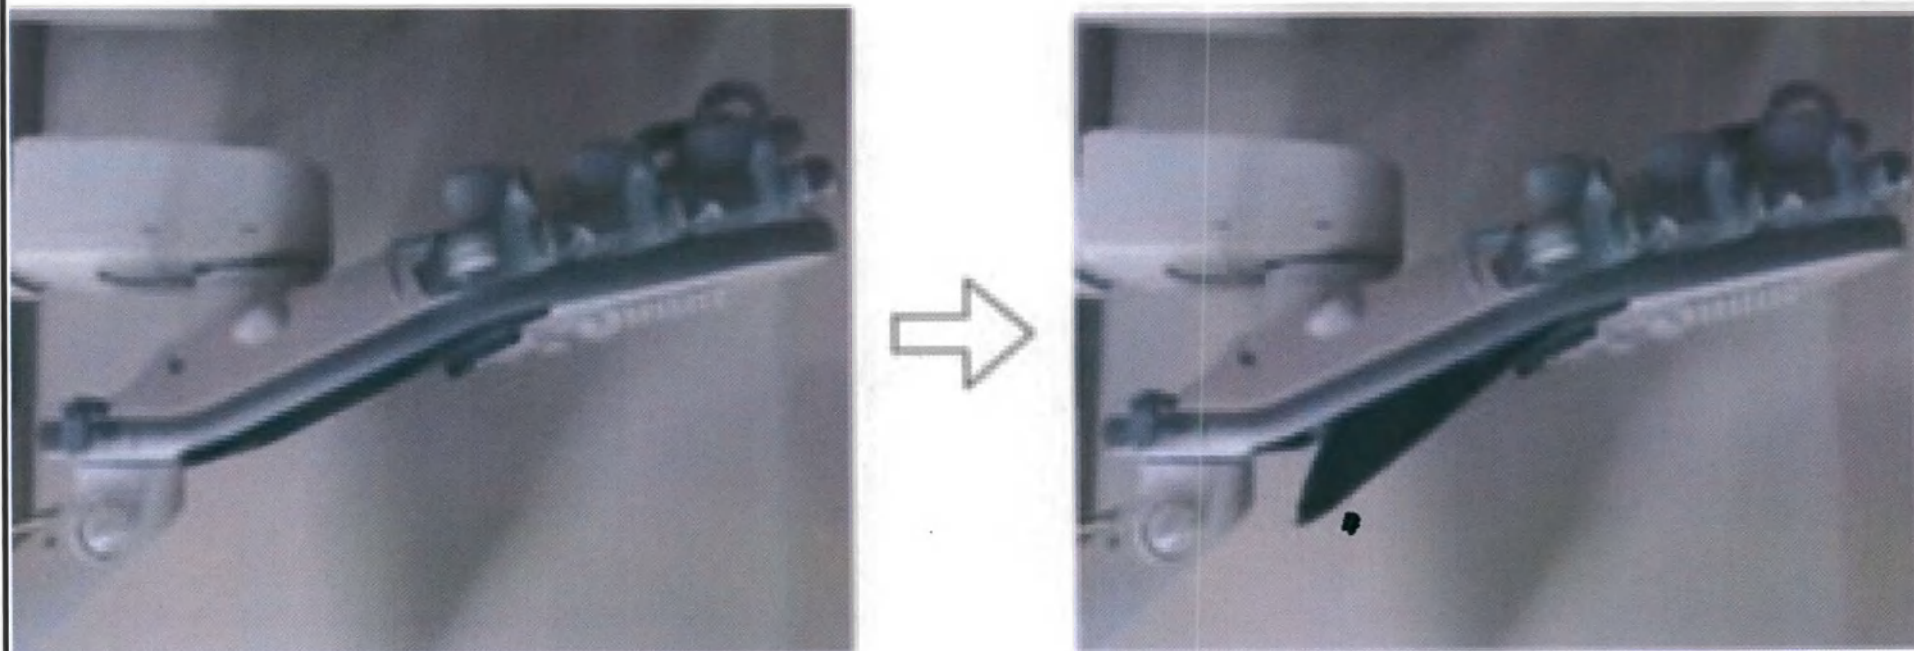



61. Трекбол обновленного вида











## 63. Модуль модернизации базового программного обеспечения (не более 10 шт.)

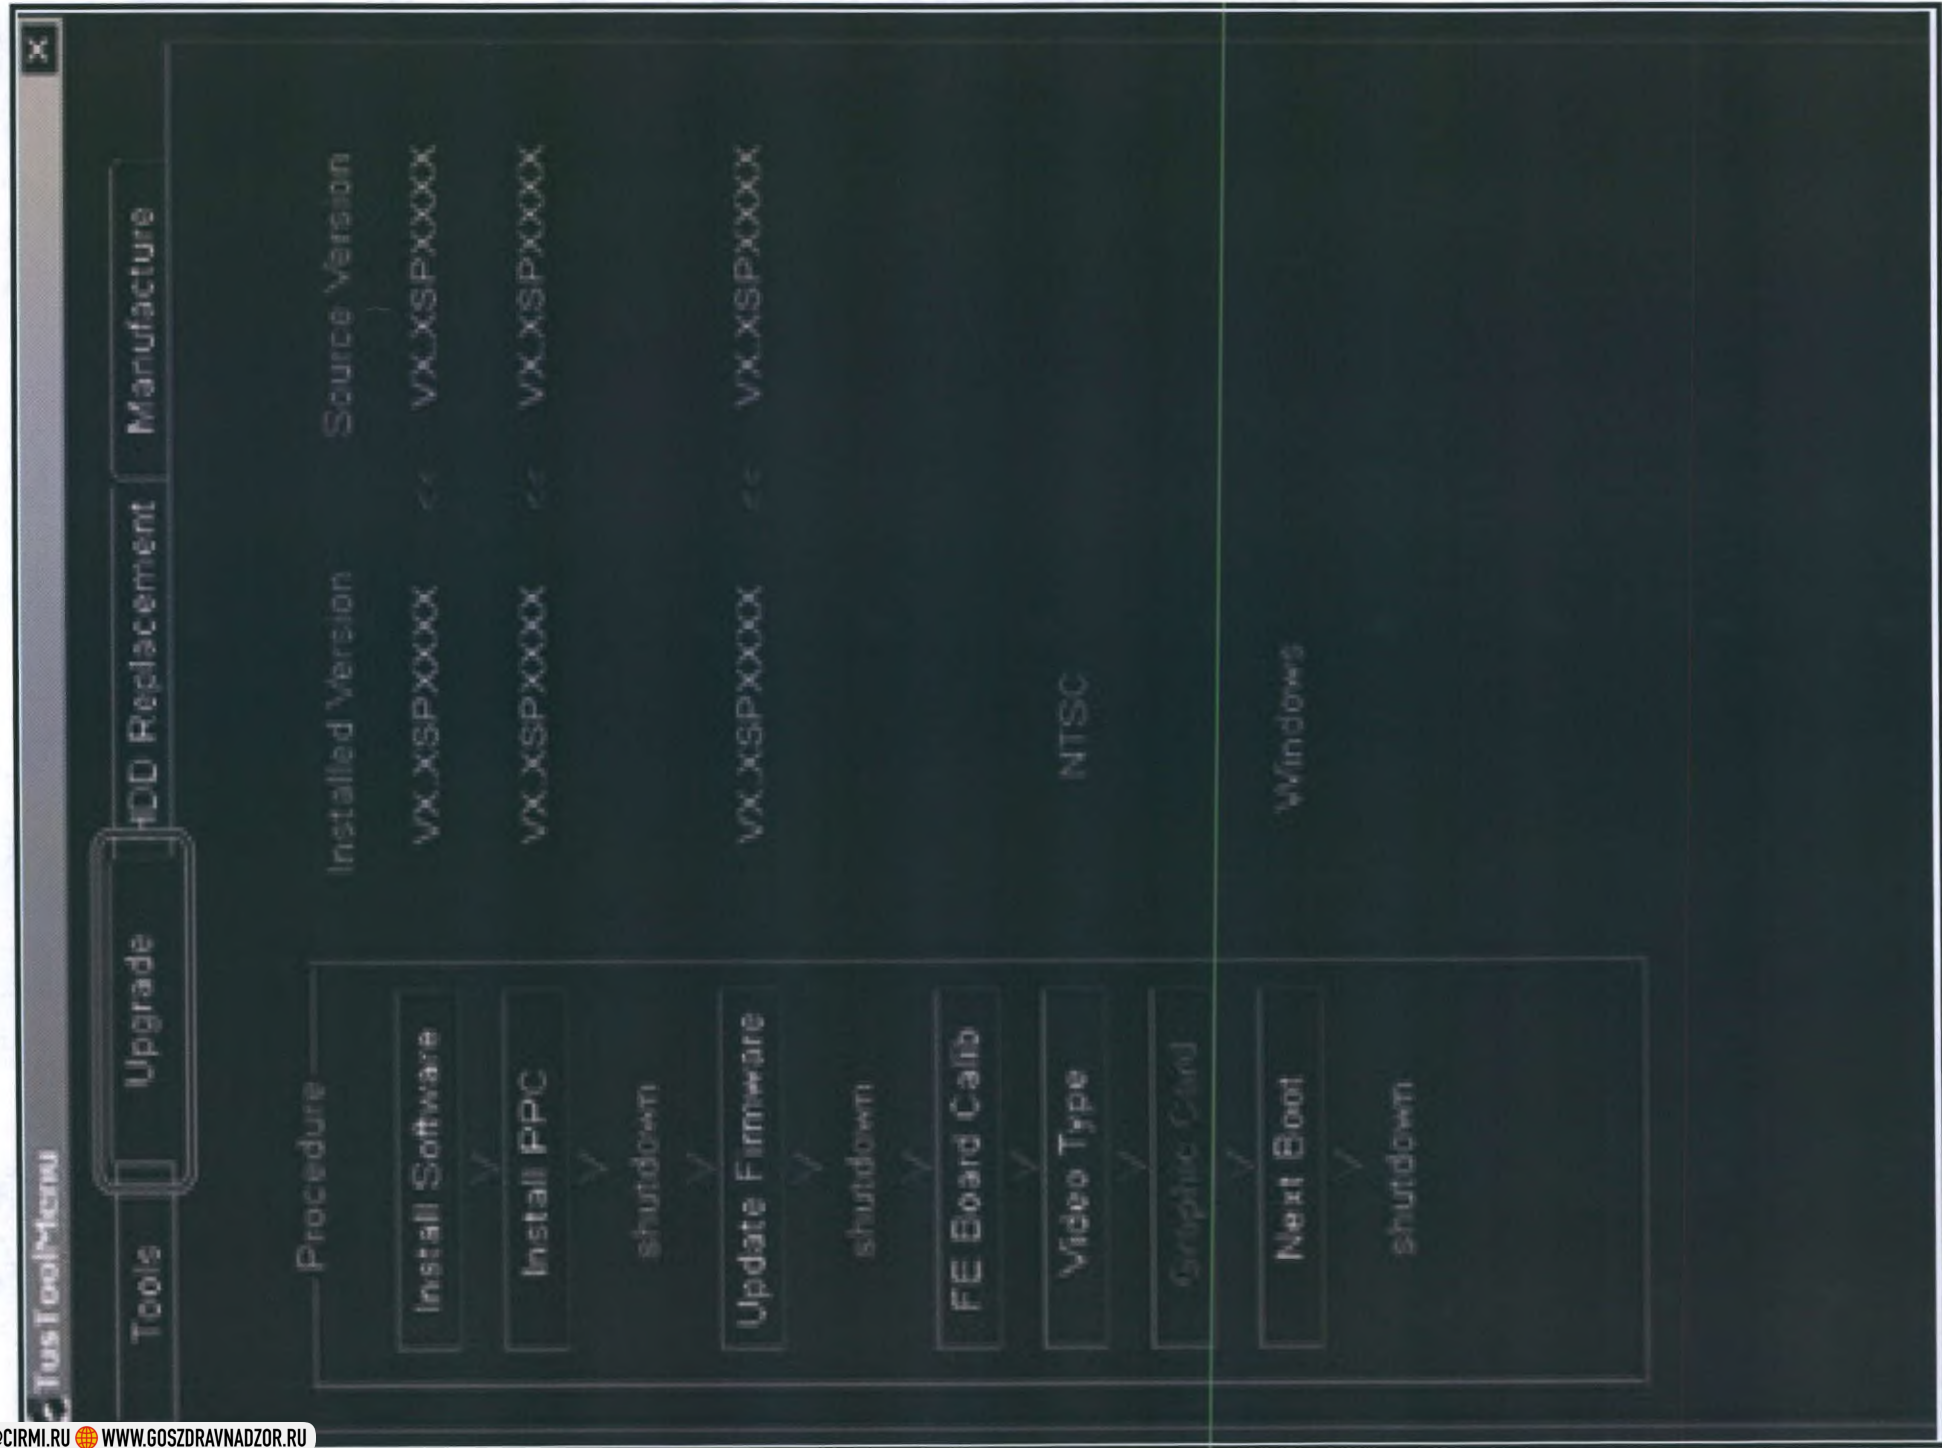




64. Крепеж для установки черно-белого принтера

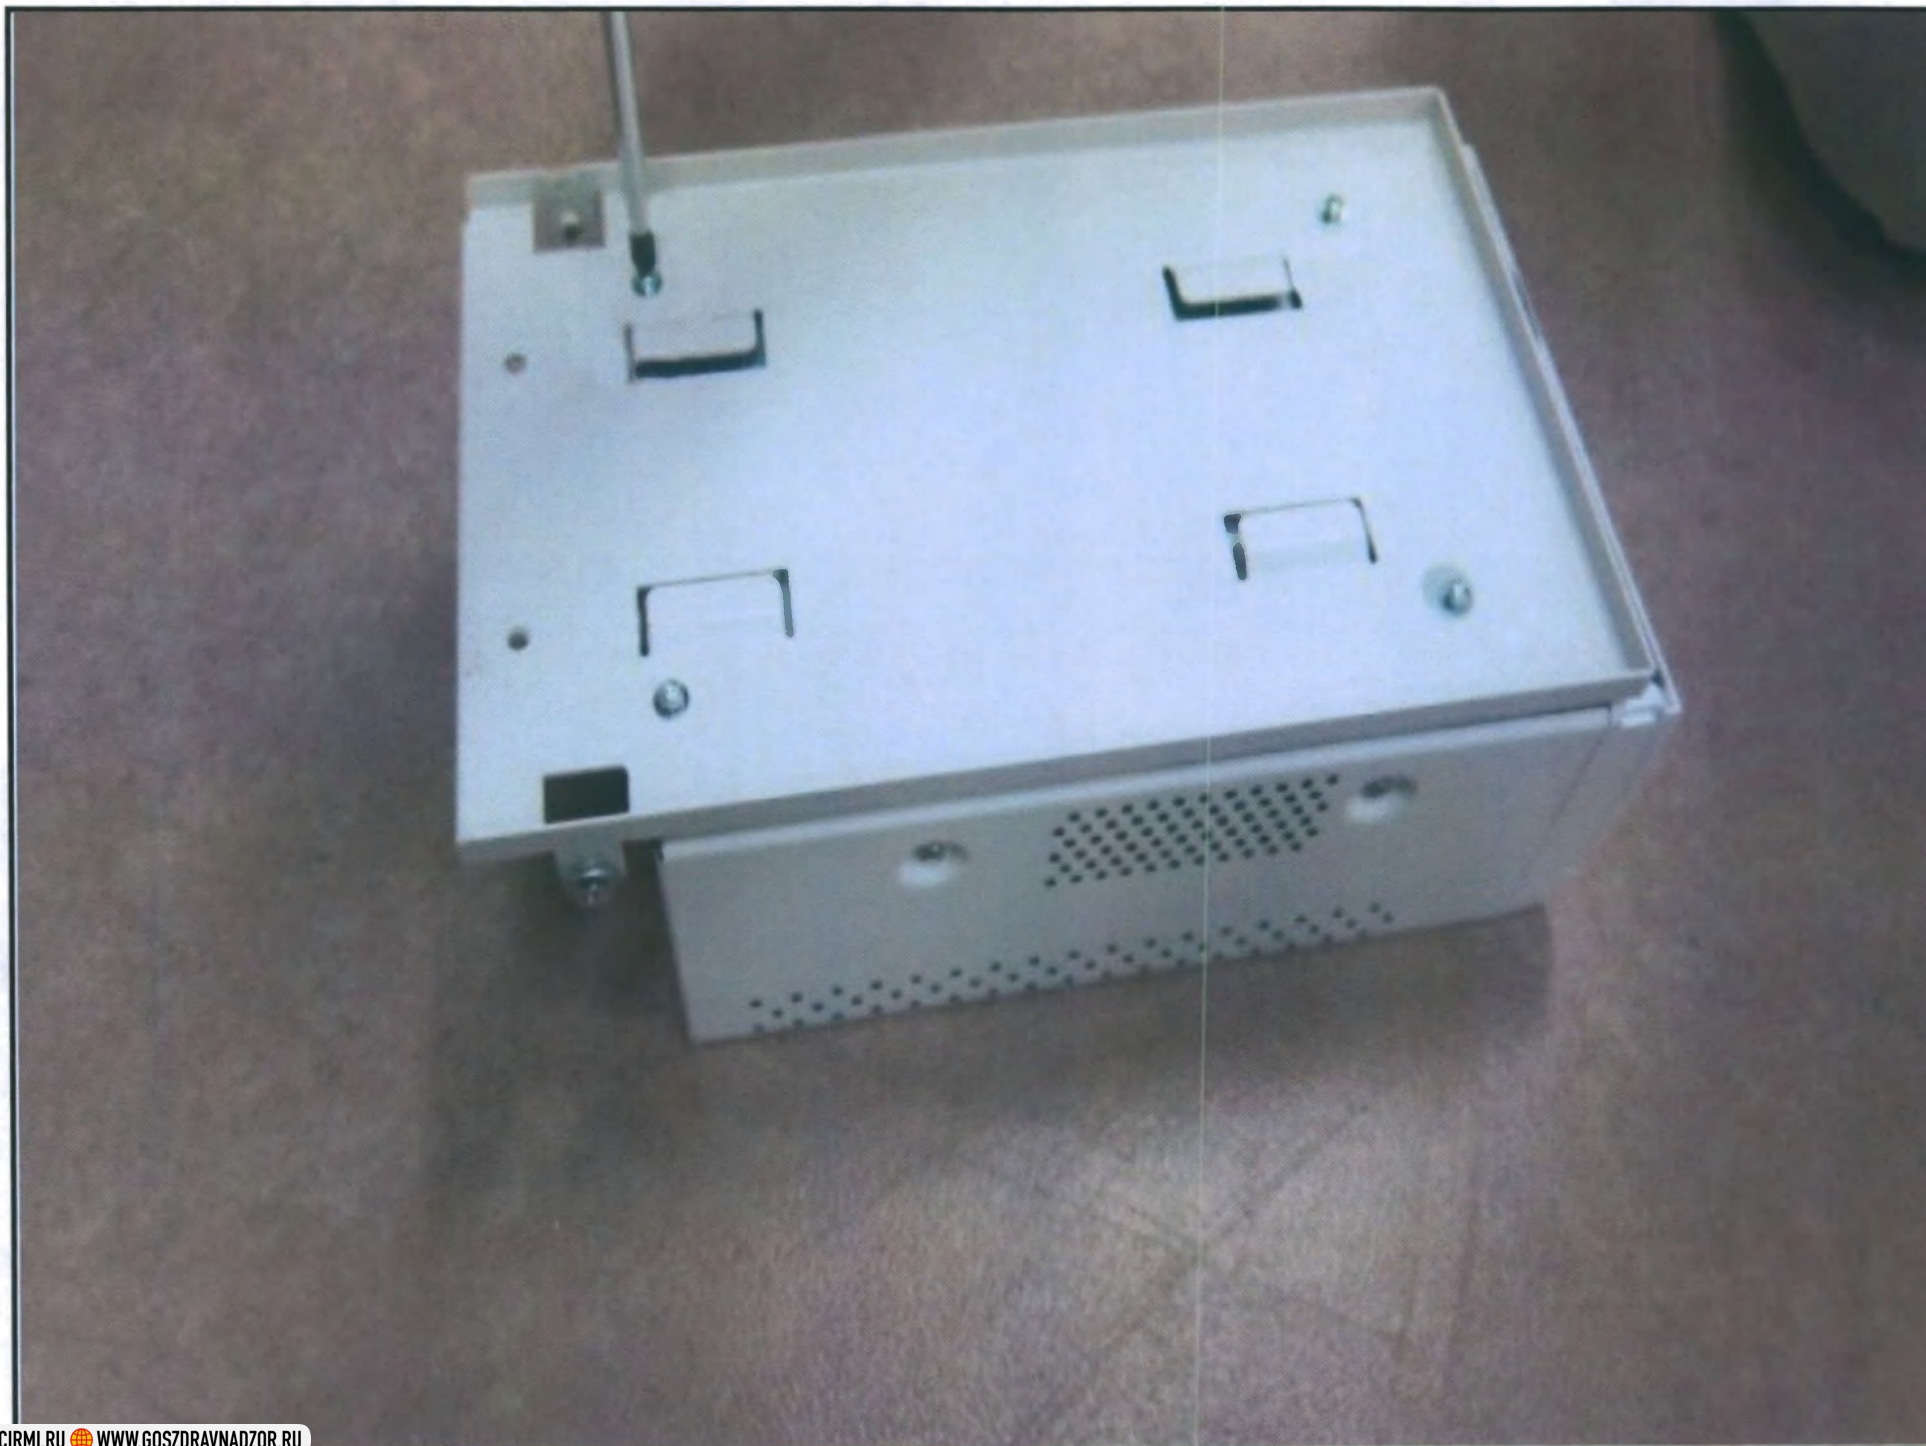



65. Крепеж для установки цветного принтера и DVD-рекодера

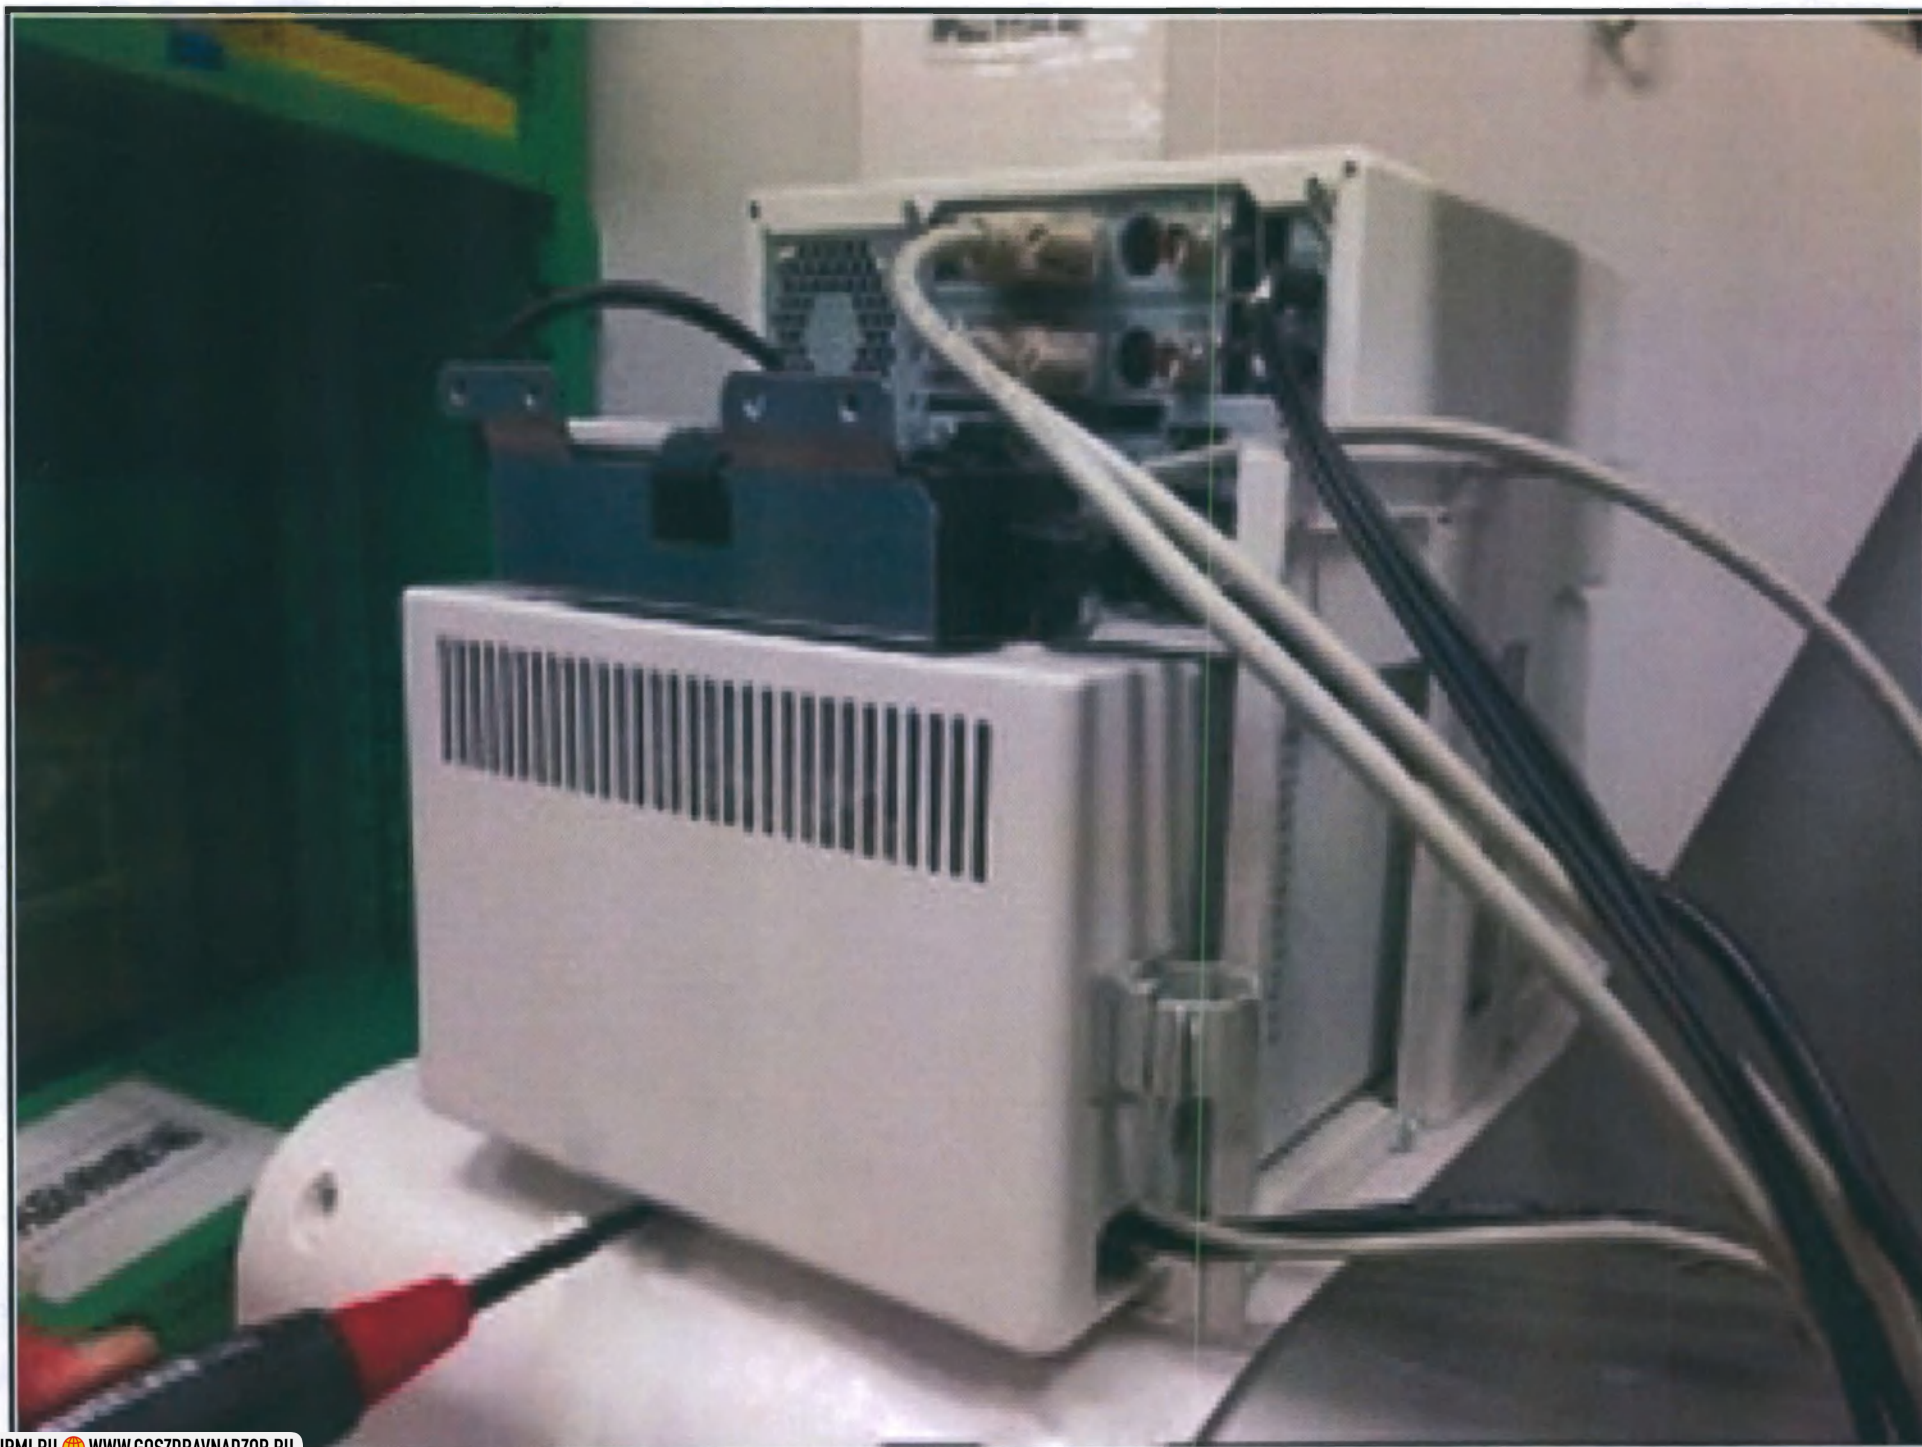



65. Крепеж для установки цветного принтера и DVD-рекодера





66. Крепеж для установки черно-белого принтера спереди или сзади





66. Крепеж для установки черно-белого принтера спереди или сзади






67. Крепеж для установки цветного принтера или DVD-рекодера в дополнение к черно-белому принтеру






67. Крепеж для установки цветного принтера или DVD-рекодера в дополнение к черно-белому принтеру

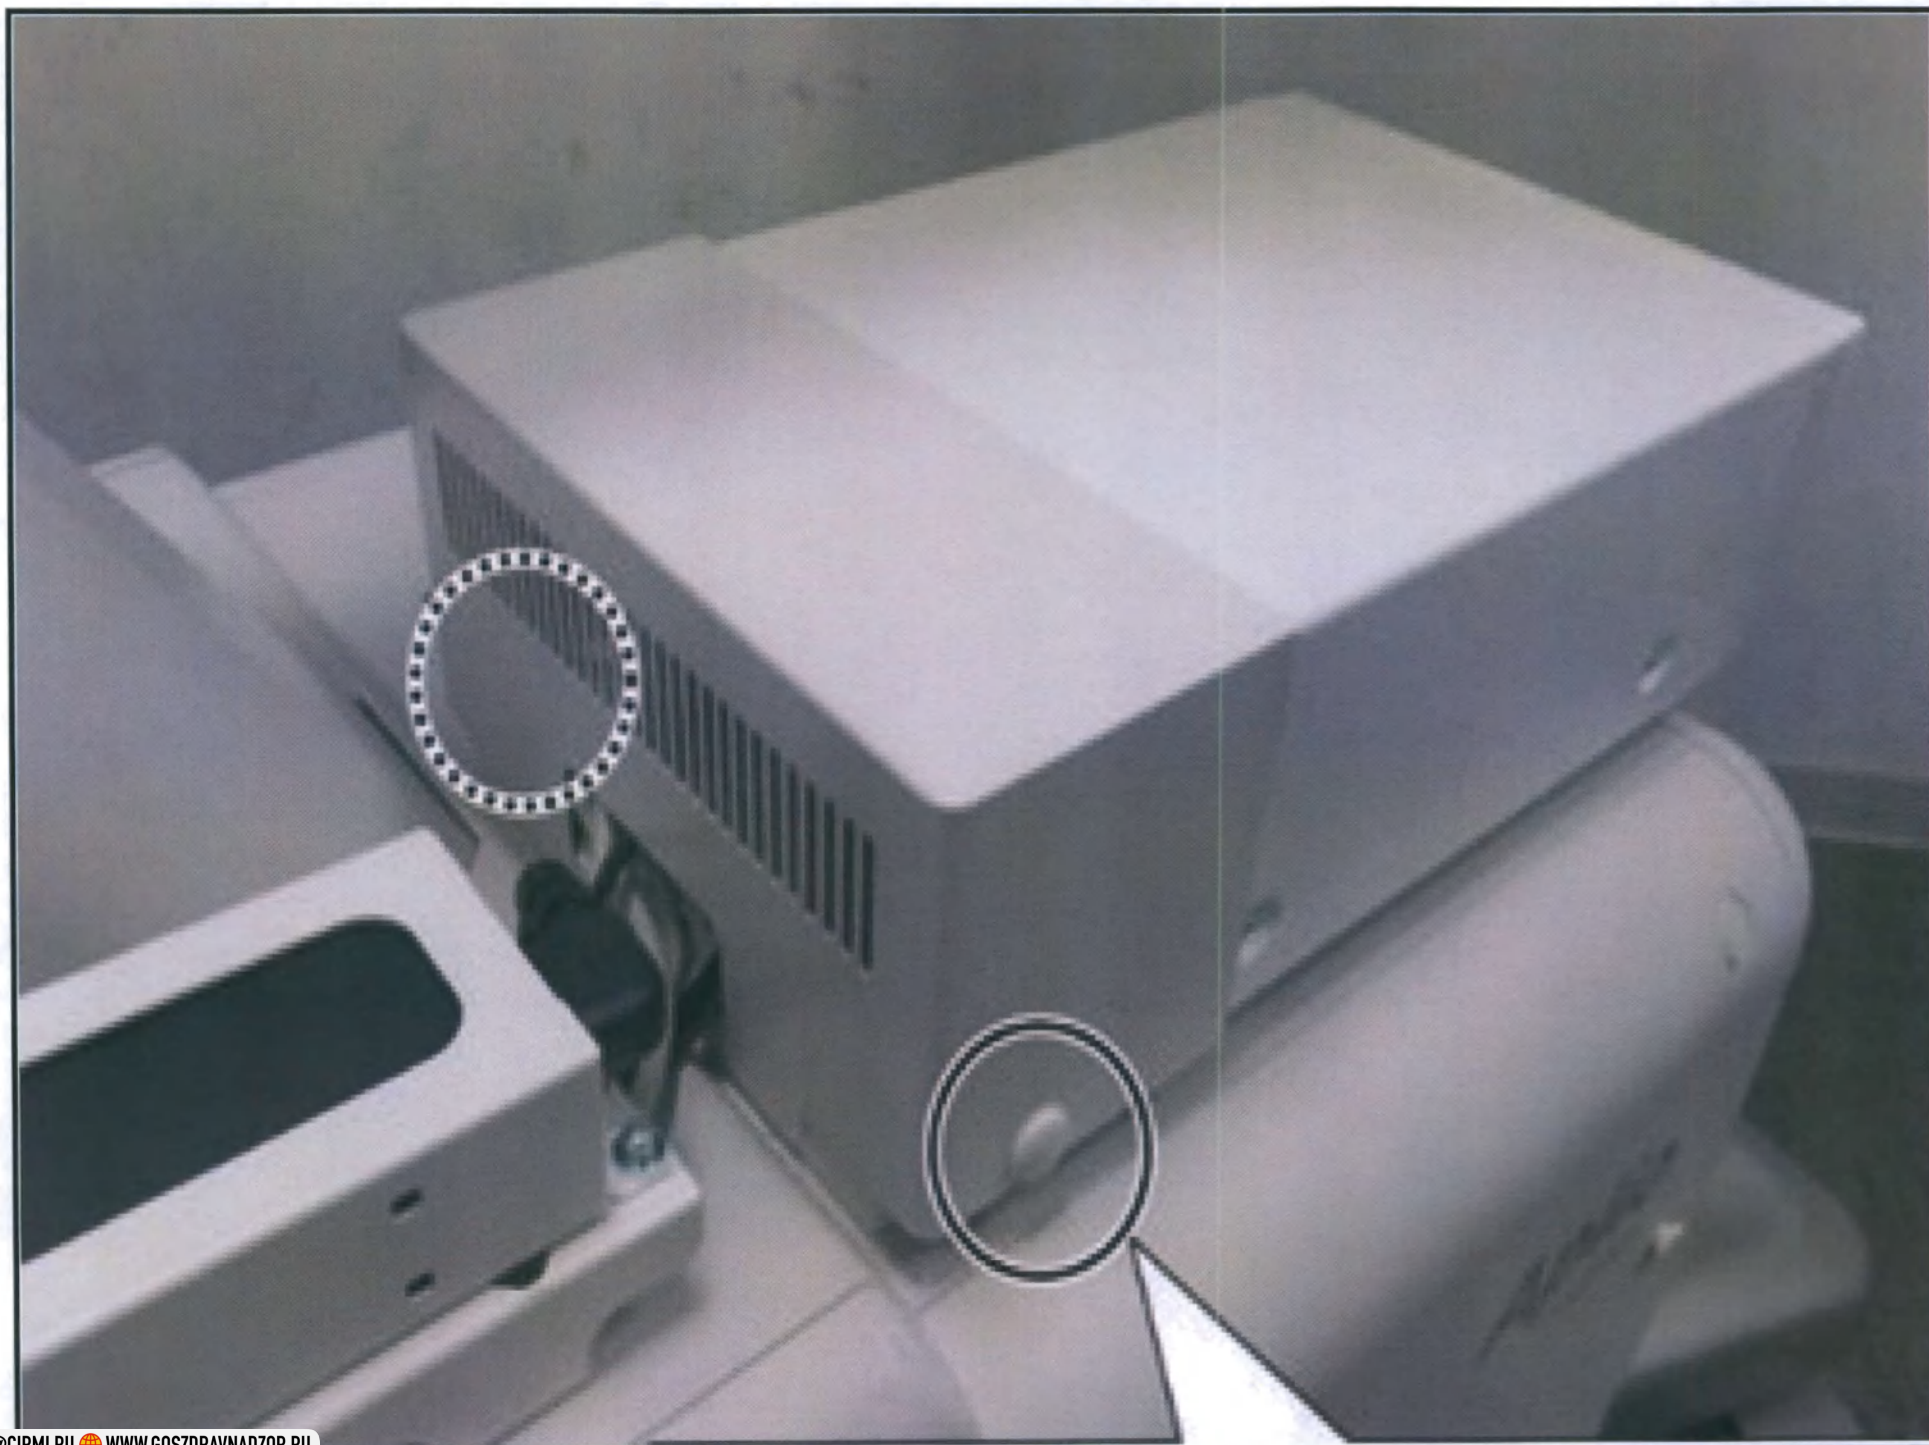




68. Программное приложение для визуализации коэффициента затухания (Attenuation Imaging)

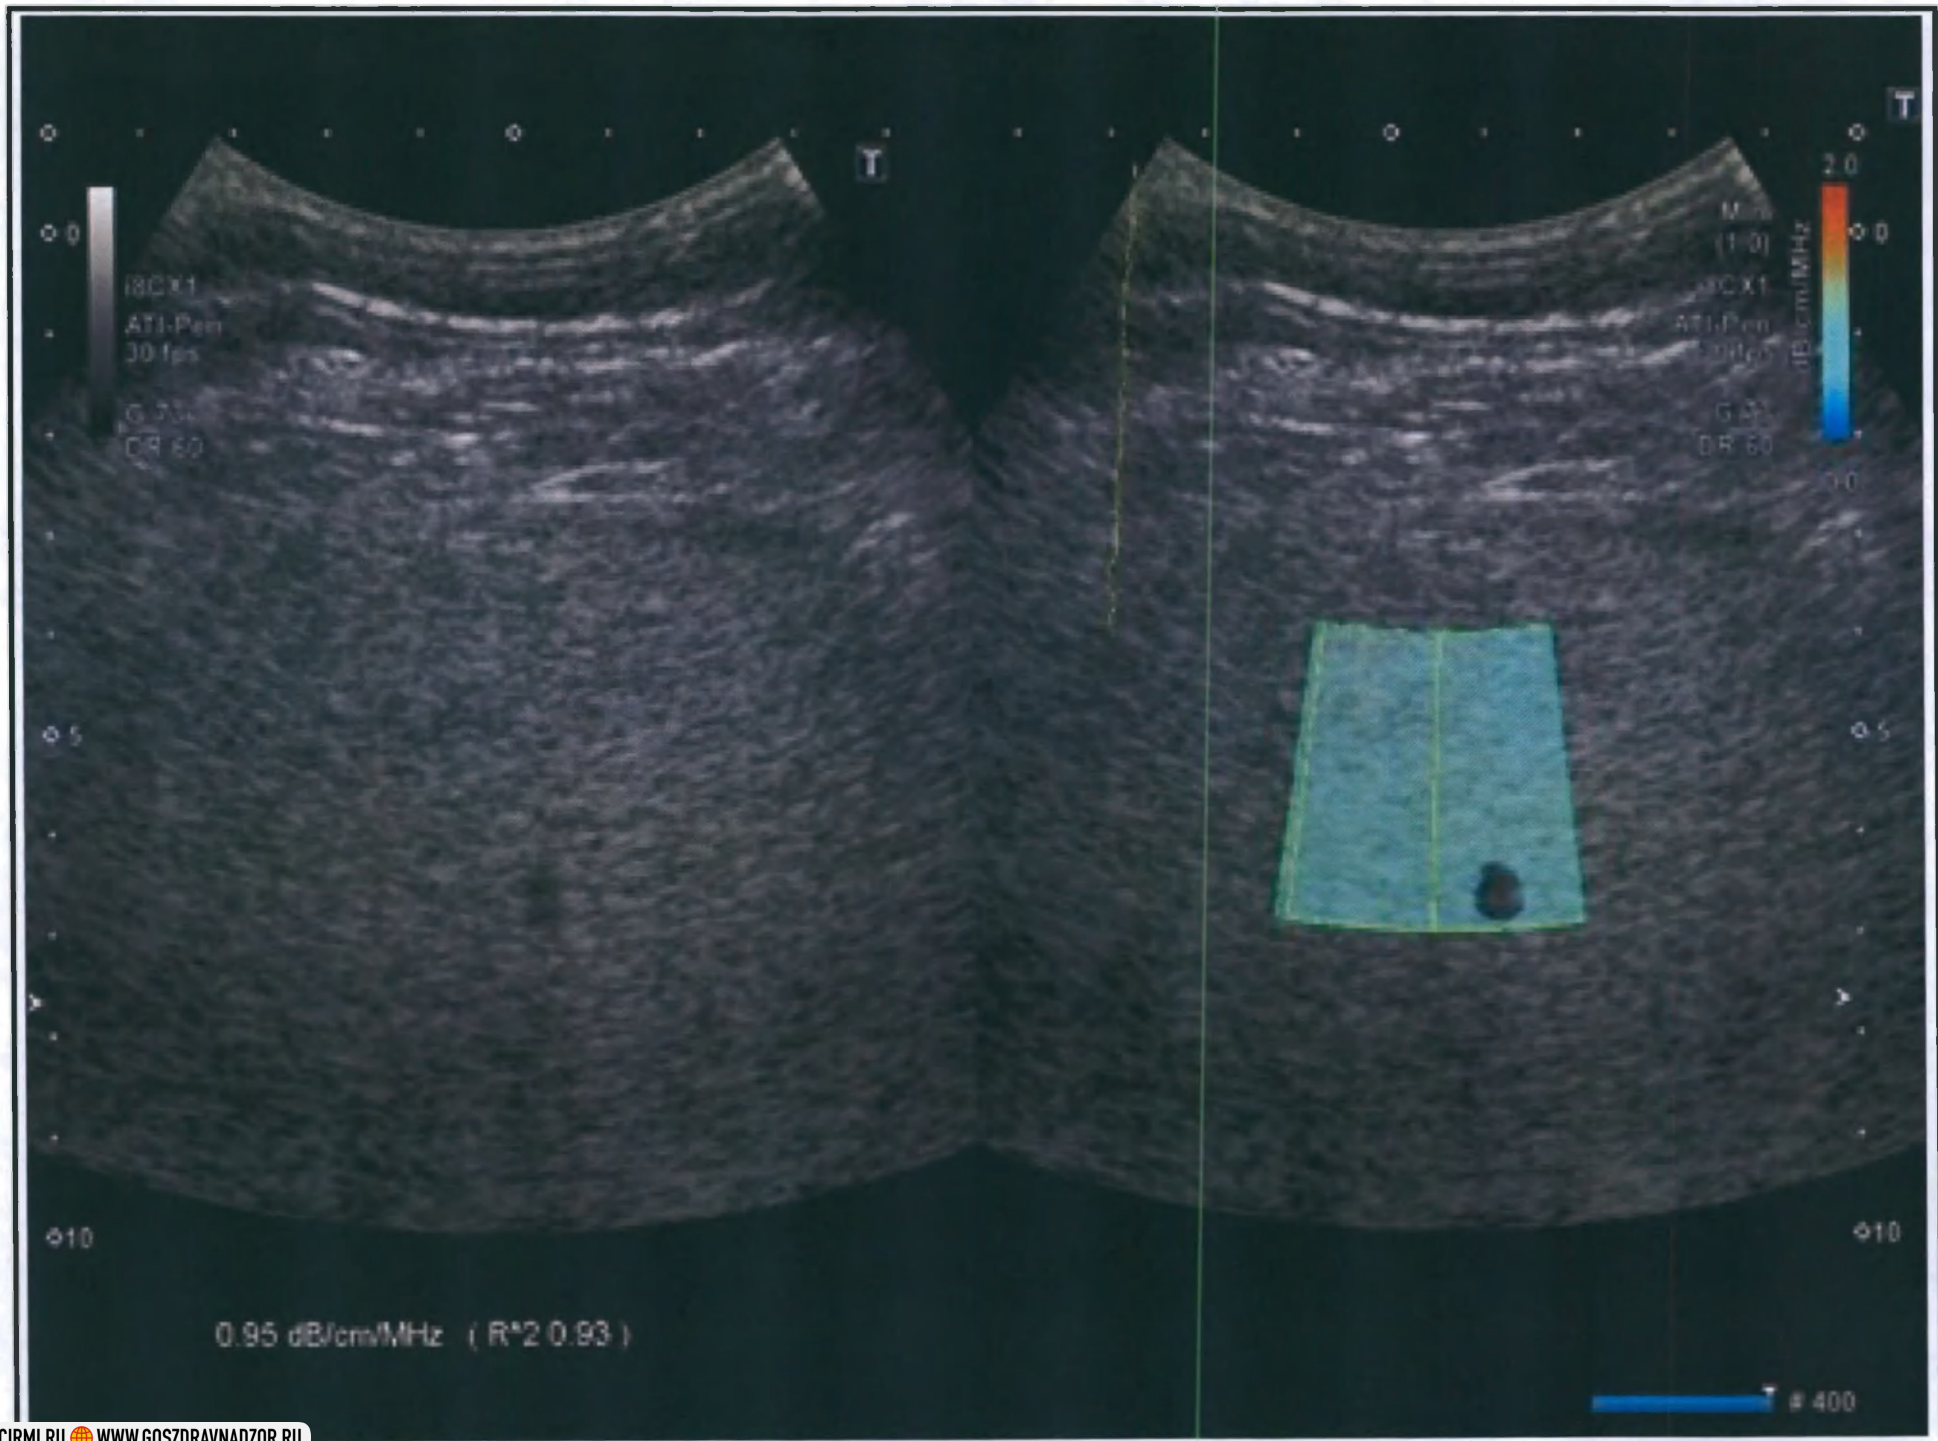



## 69. Программное приложение для мультипараметрических отчетов (Multi Parametric Report)

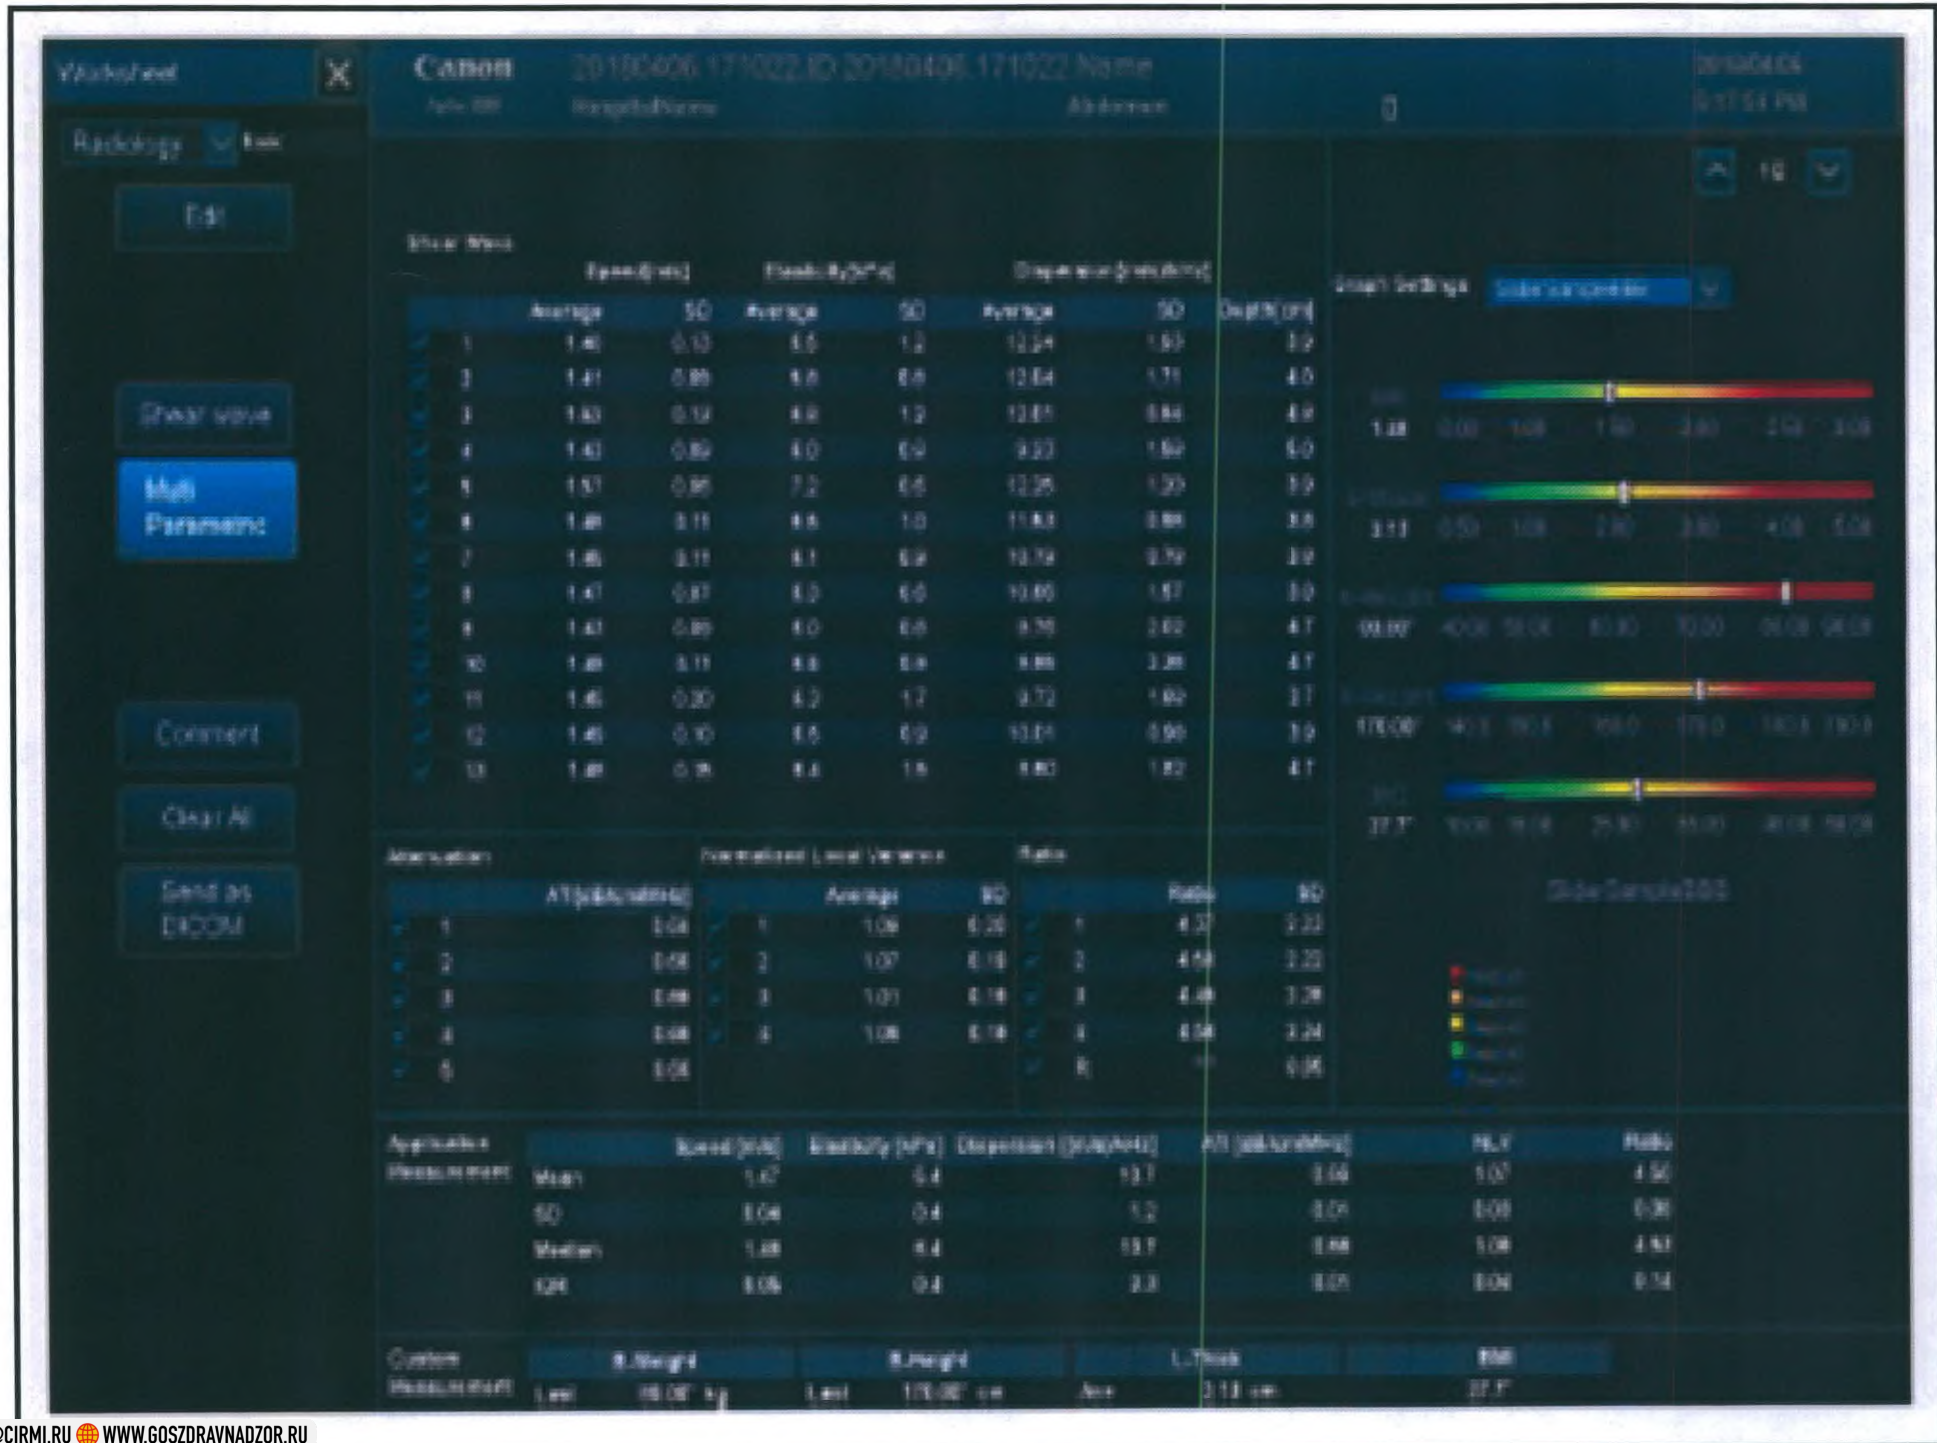




## 70. Программное приложение RADS






# 71. Программное приложение для исследования сердца плода (Smart Fetal Heart)

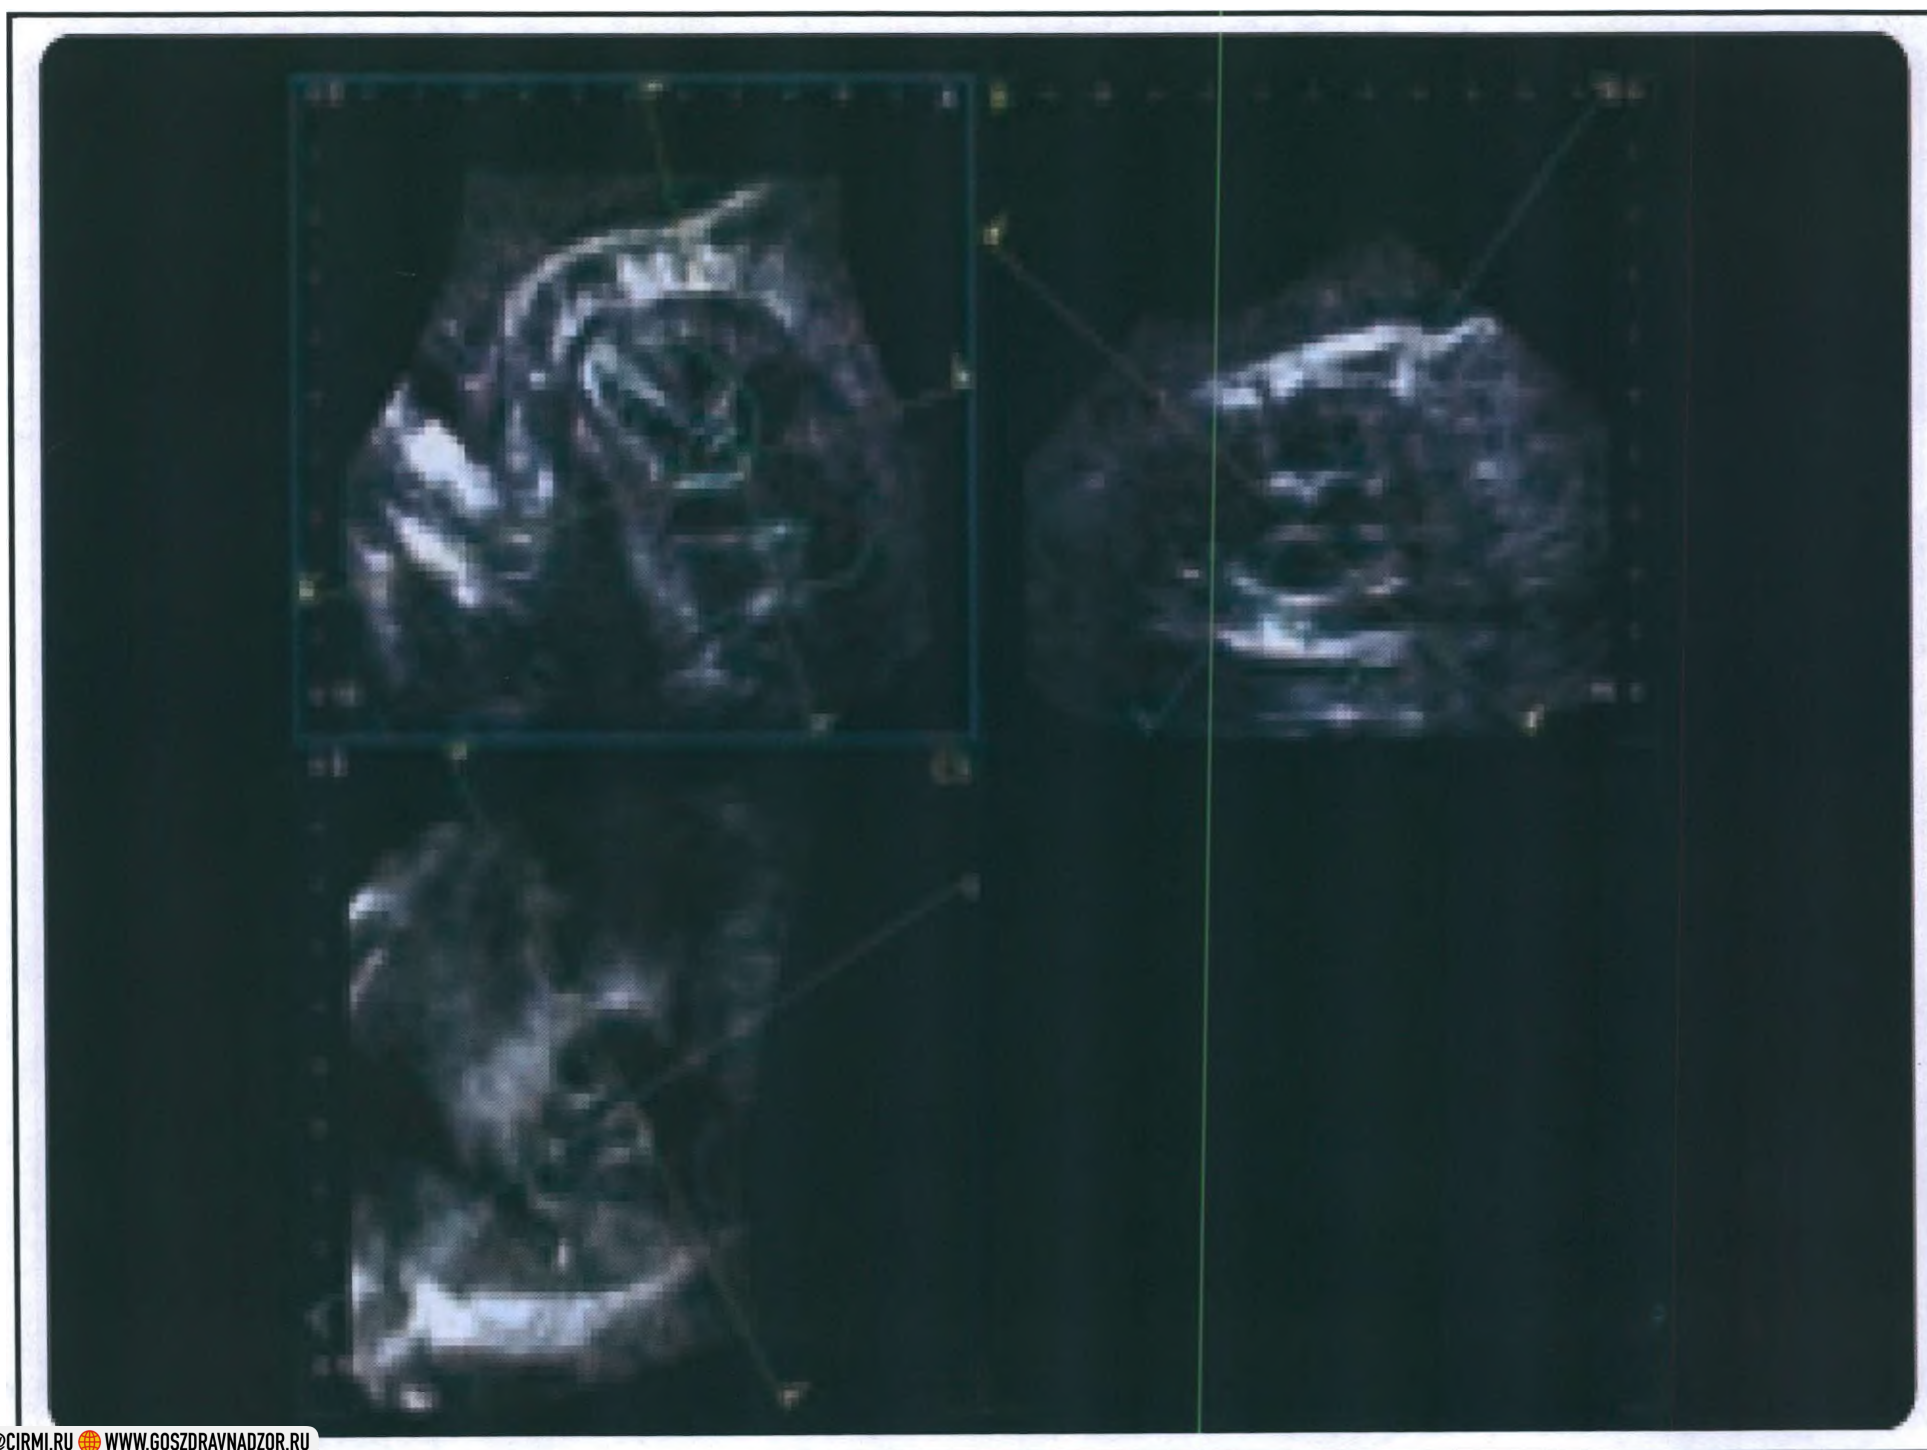



72. Программное приложение для отслеживания движения стенок миокарда сердца плода в 2D режиме (2D Wall Motion Tracking Fetal)

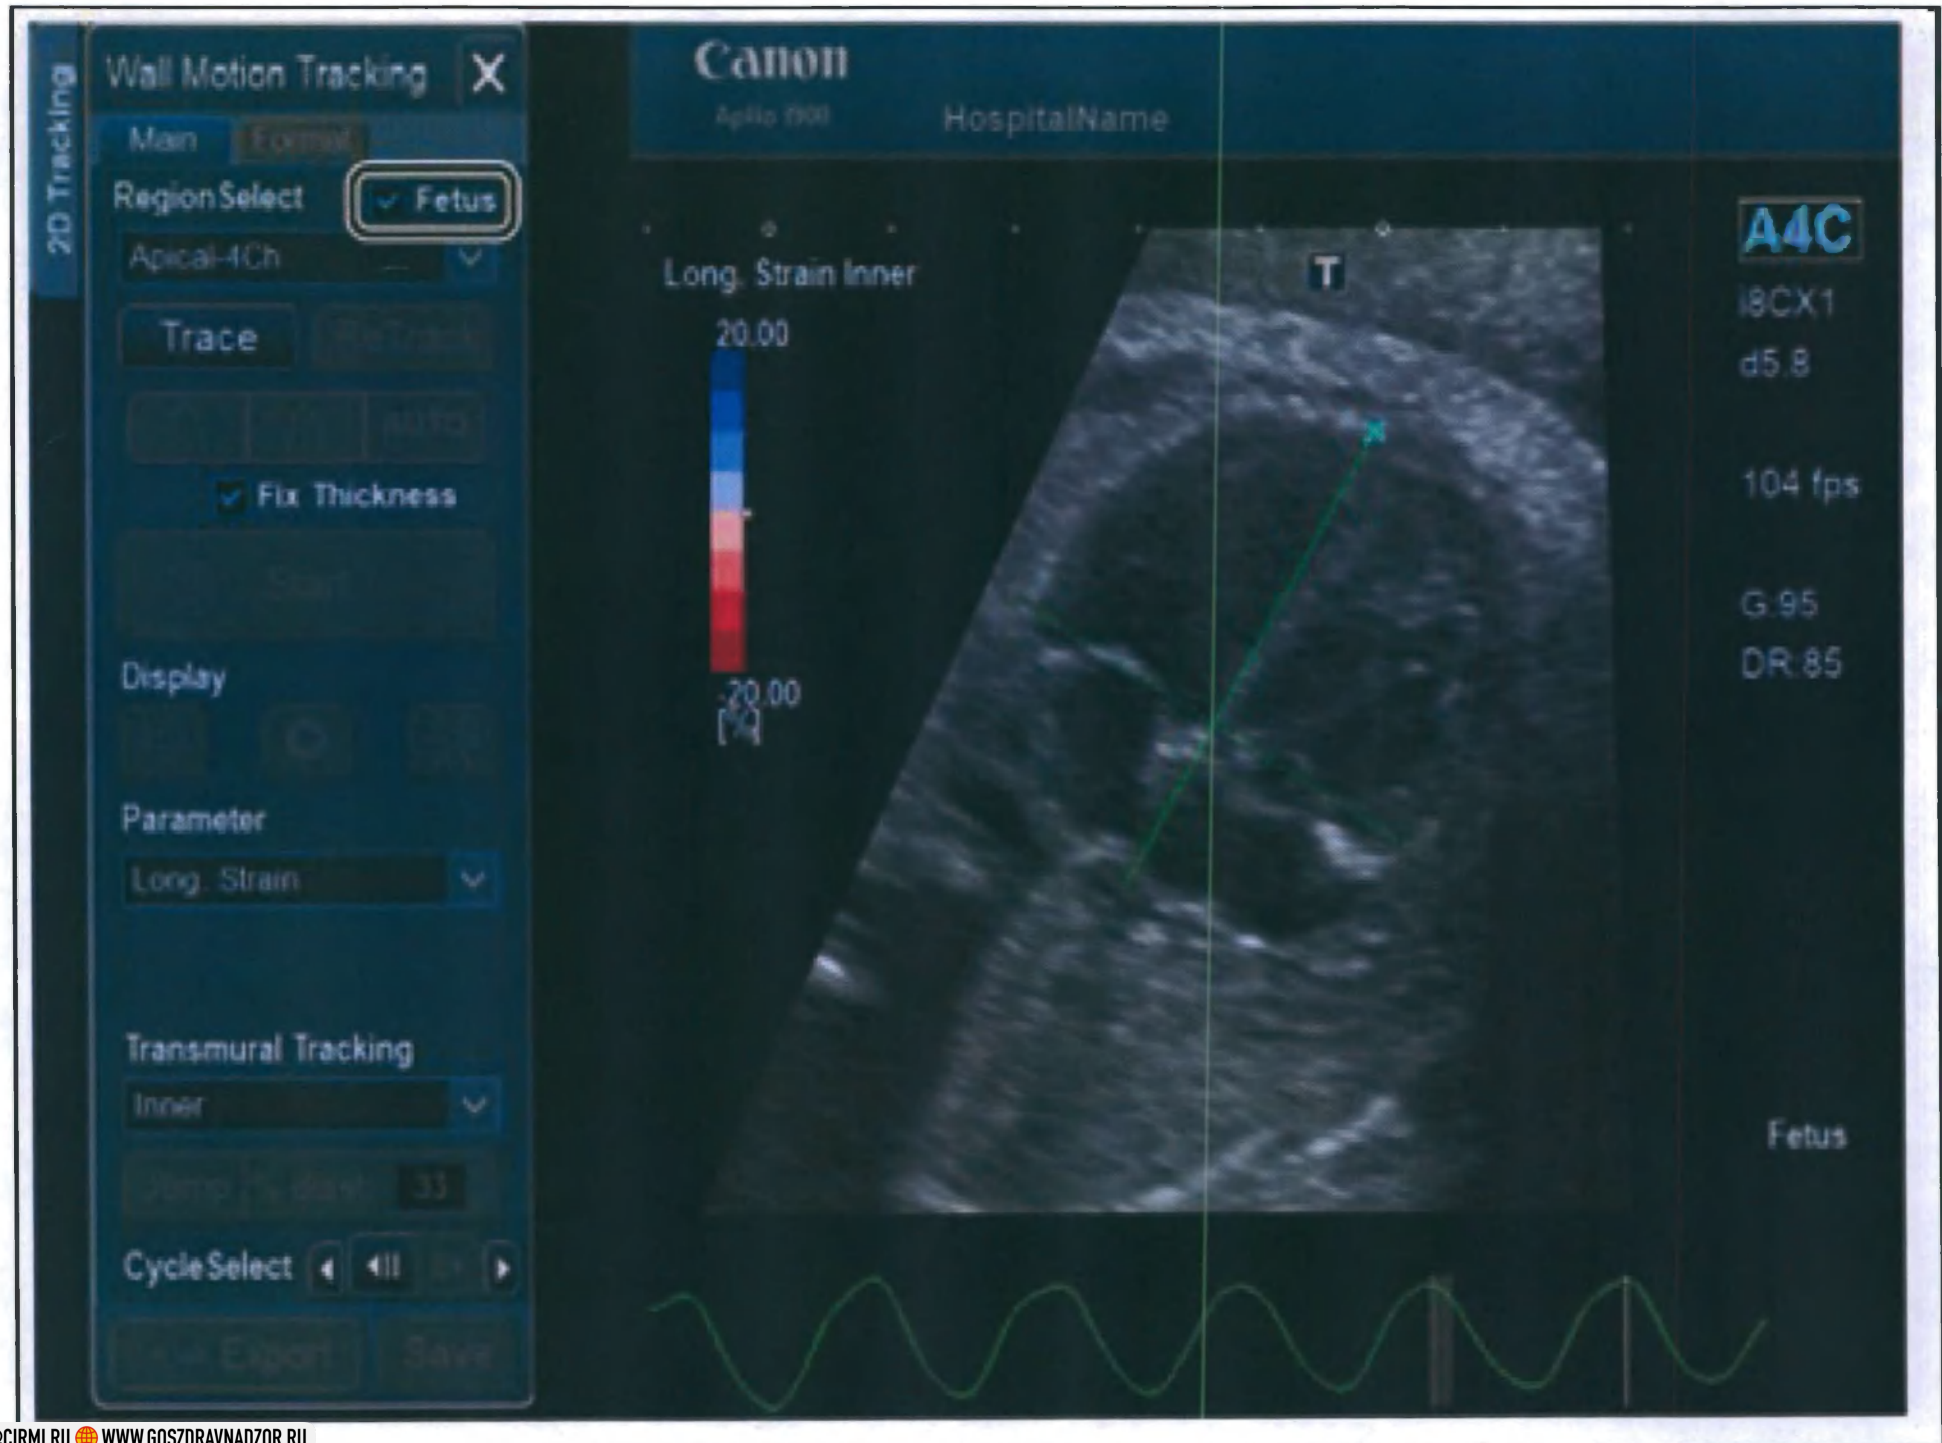




### 73. Модуль Palm Controller






## 73. Модуль Palm Controller

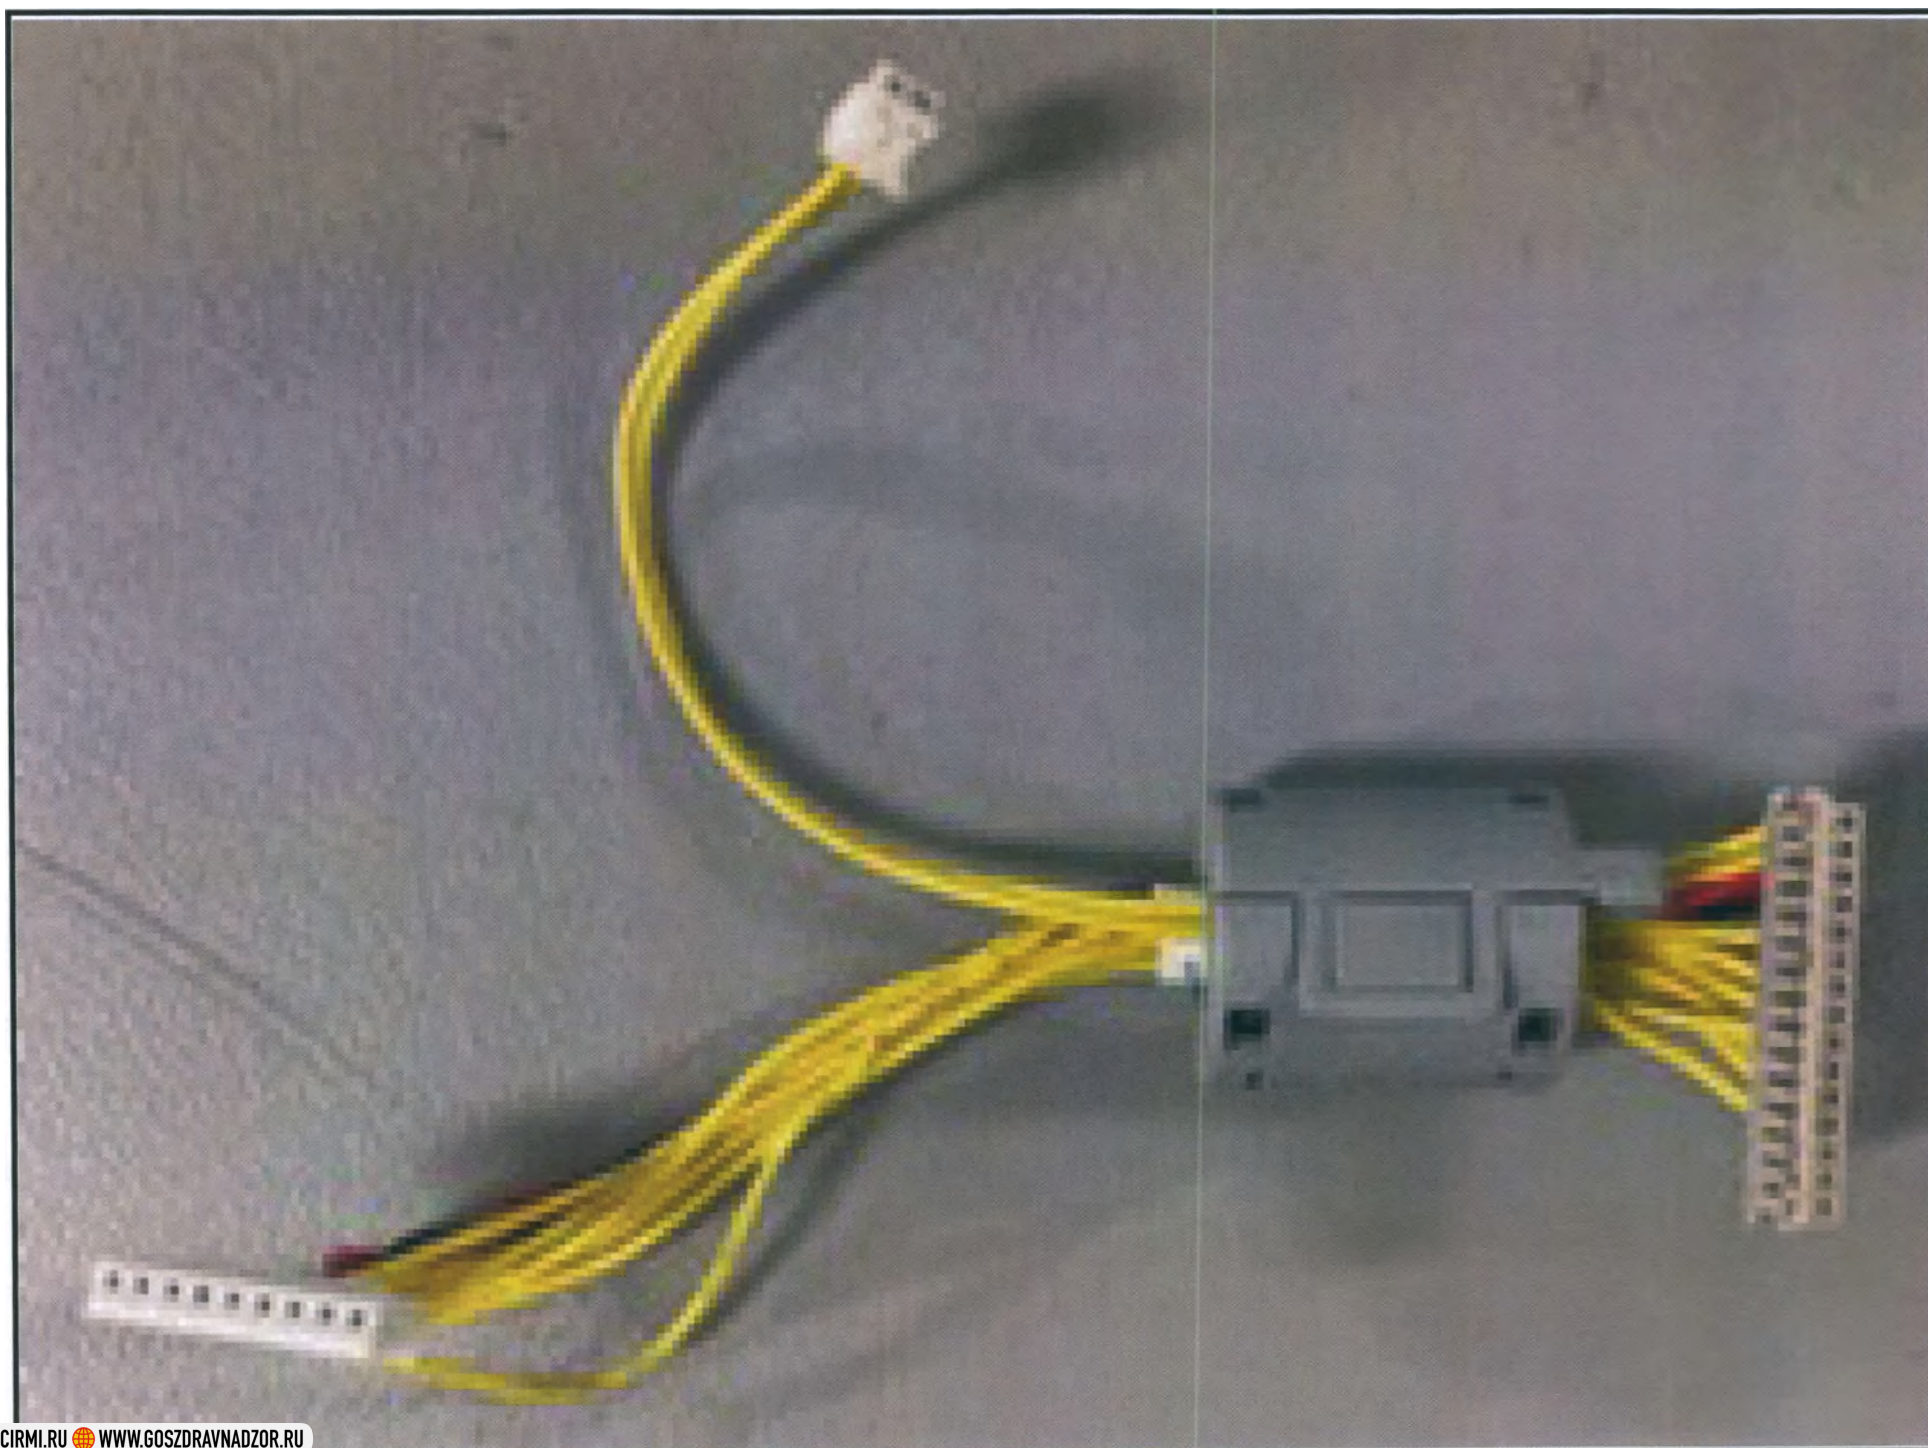




#### 74. Программное приложение для измерений (Measurement Assistant)

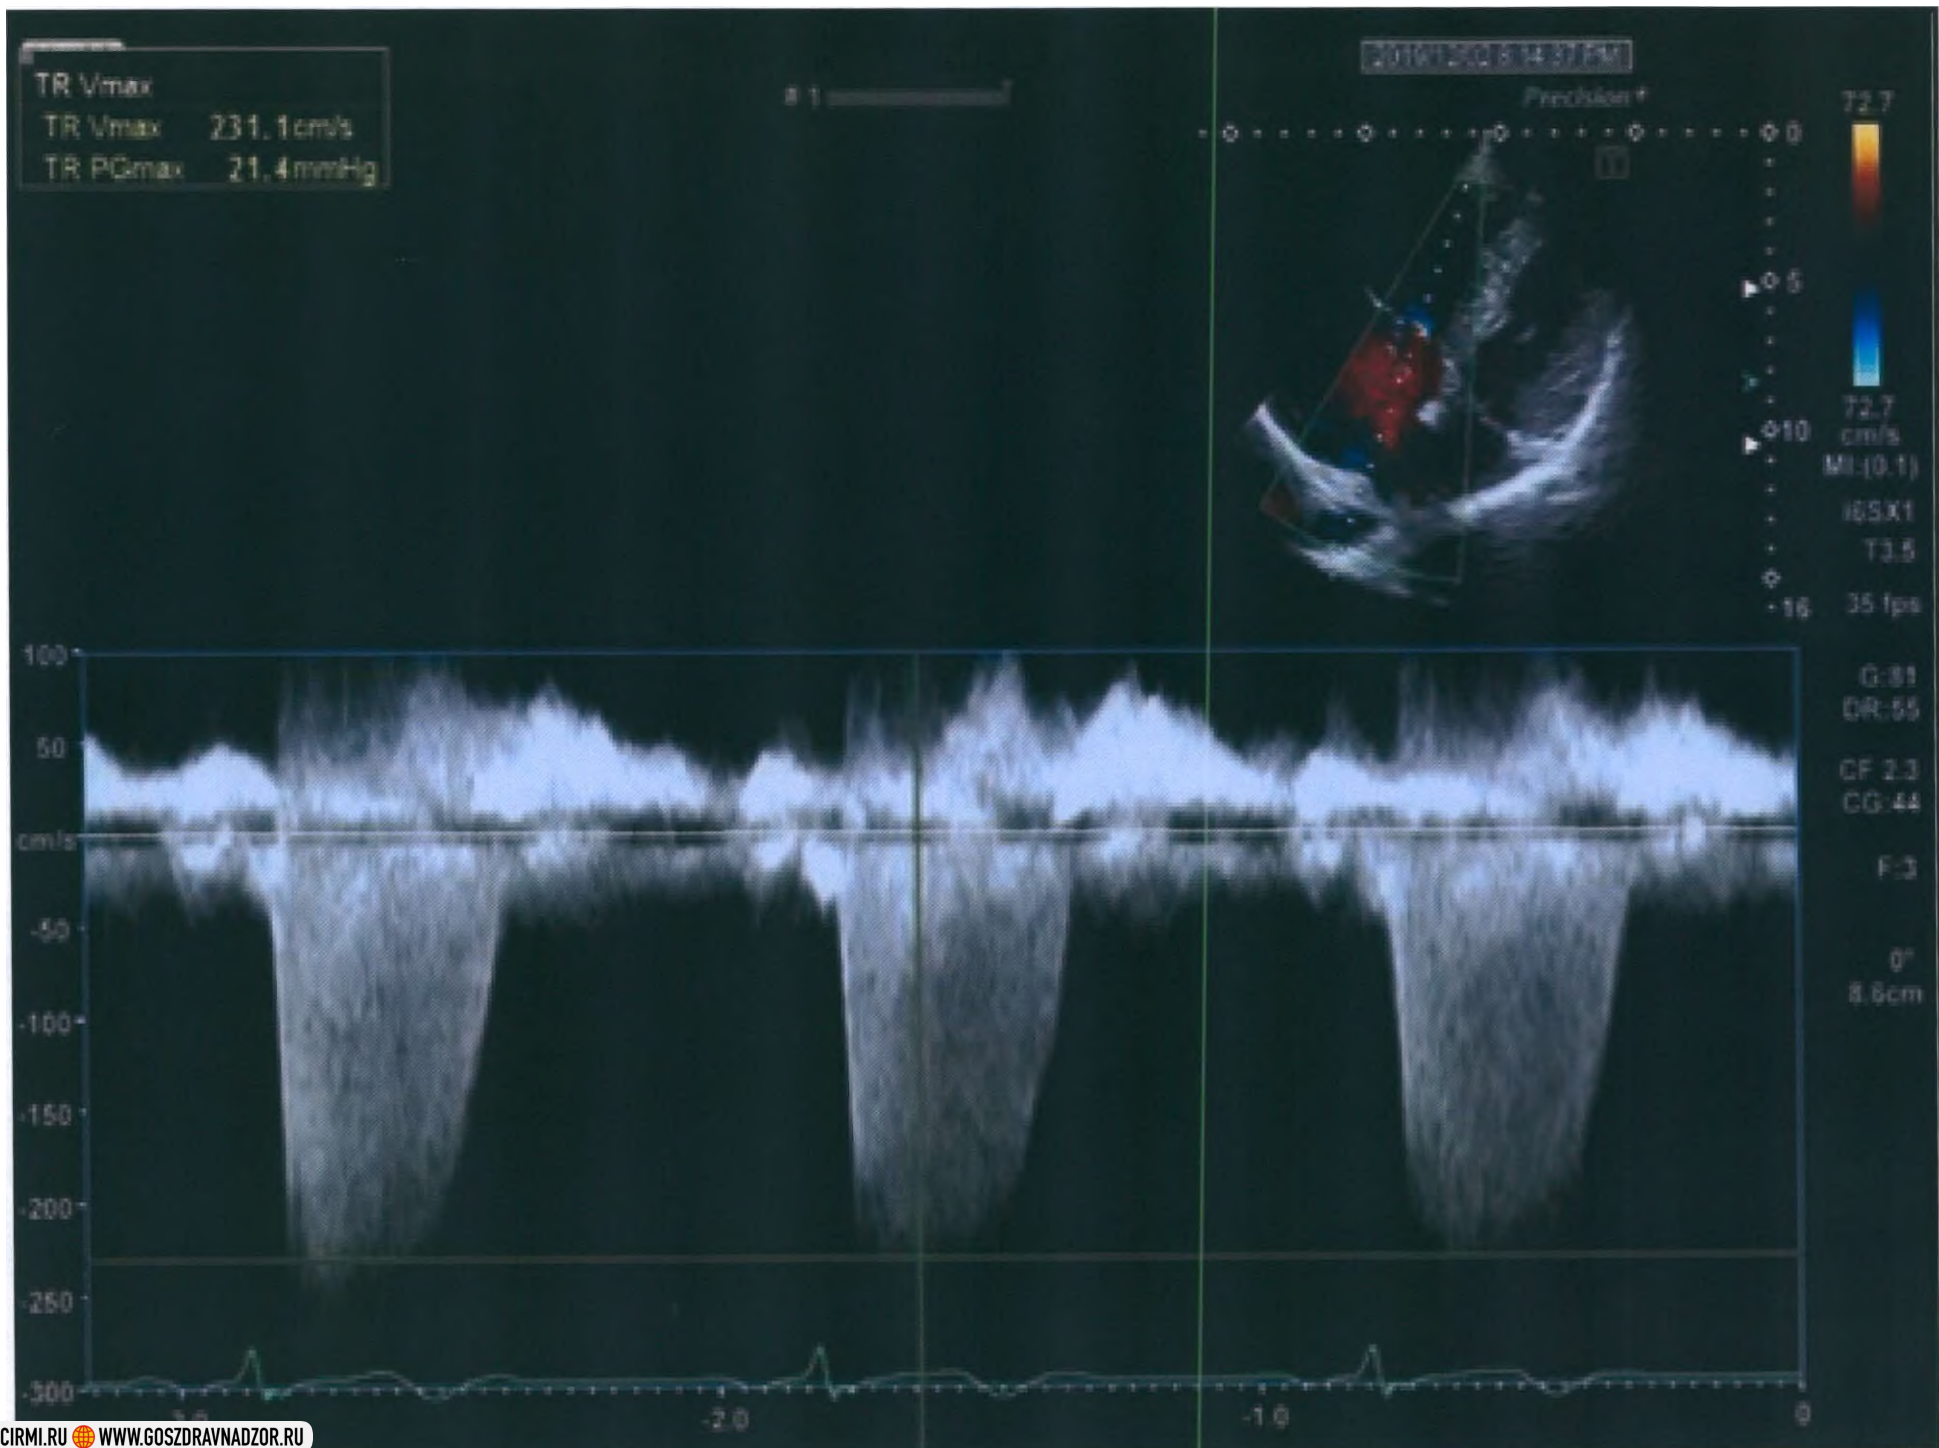



75. Программное приложение для эластографии сдвиговой волной повышенного давления (Shear wave Hard)

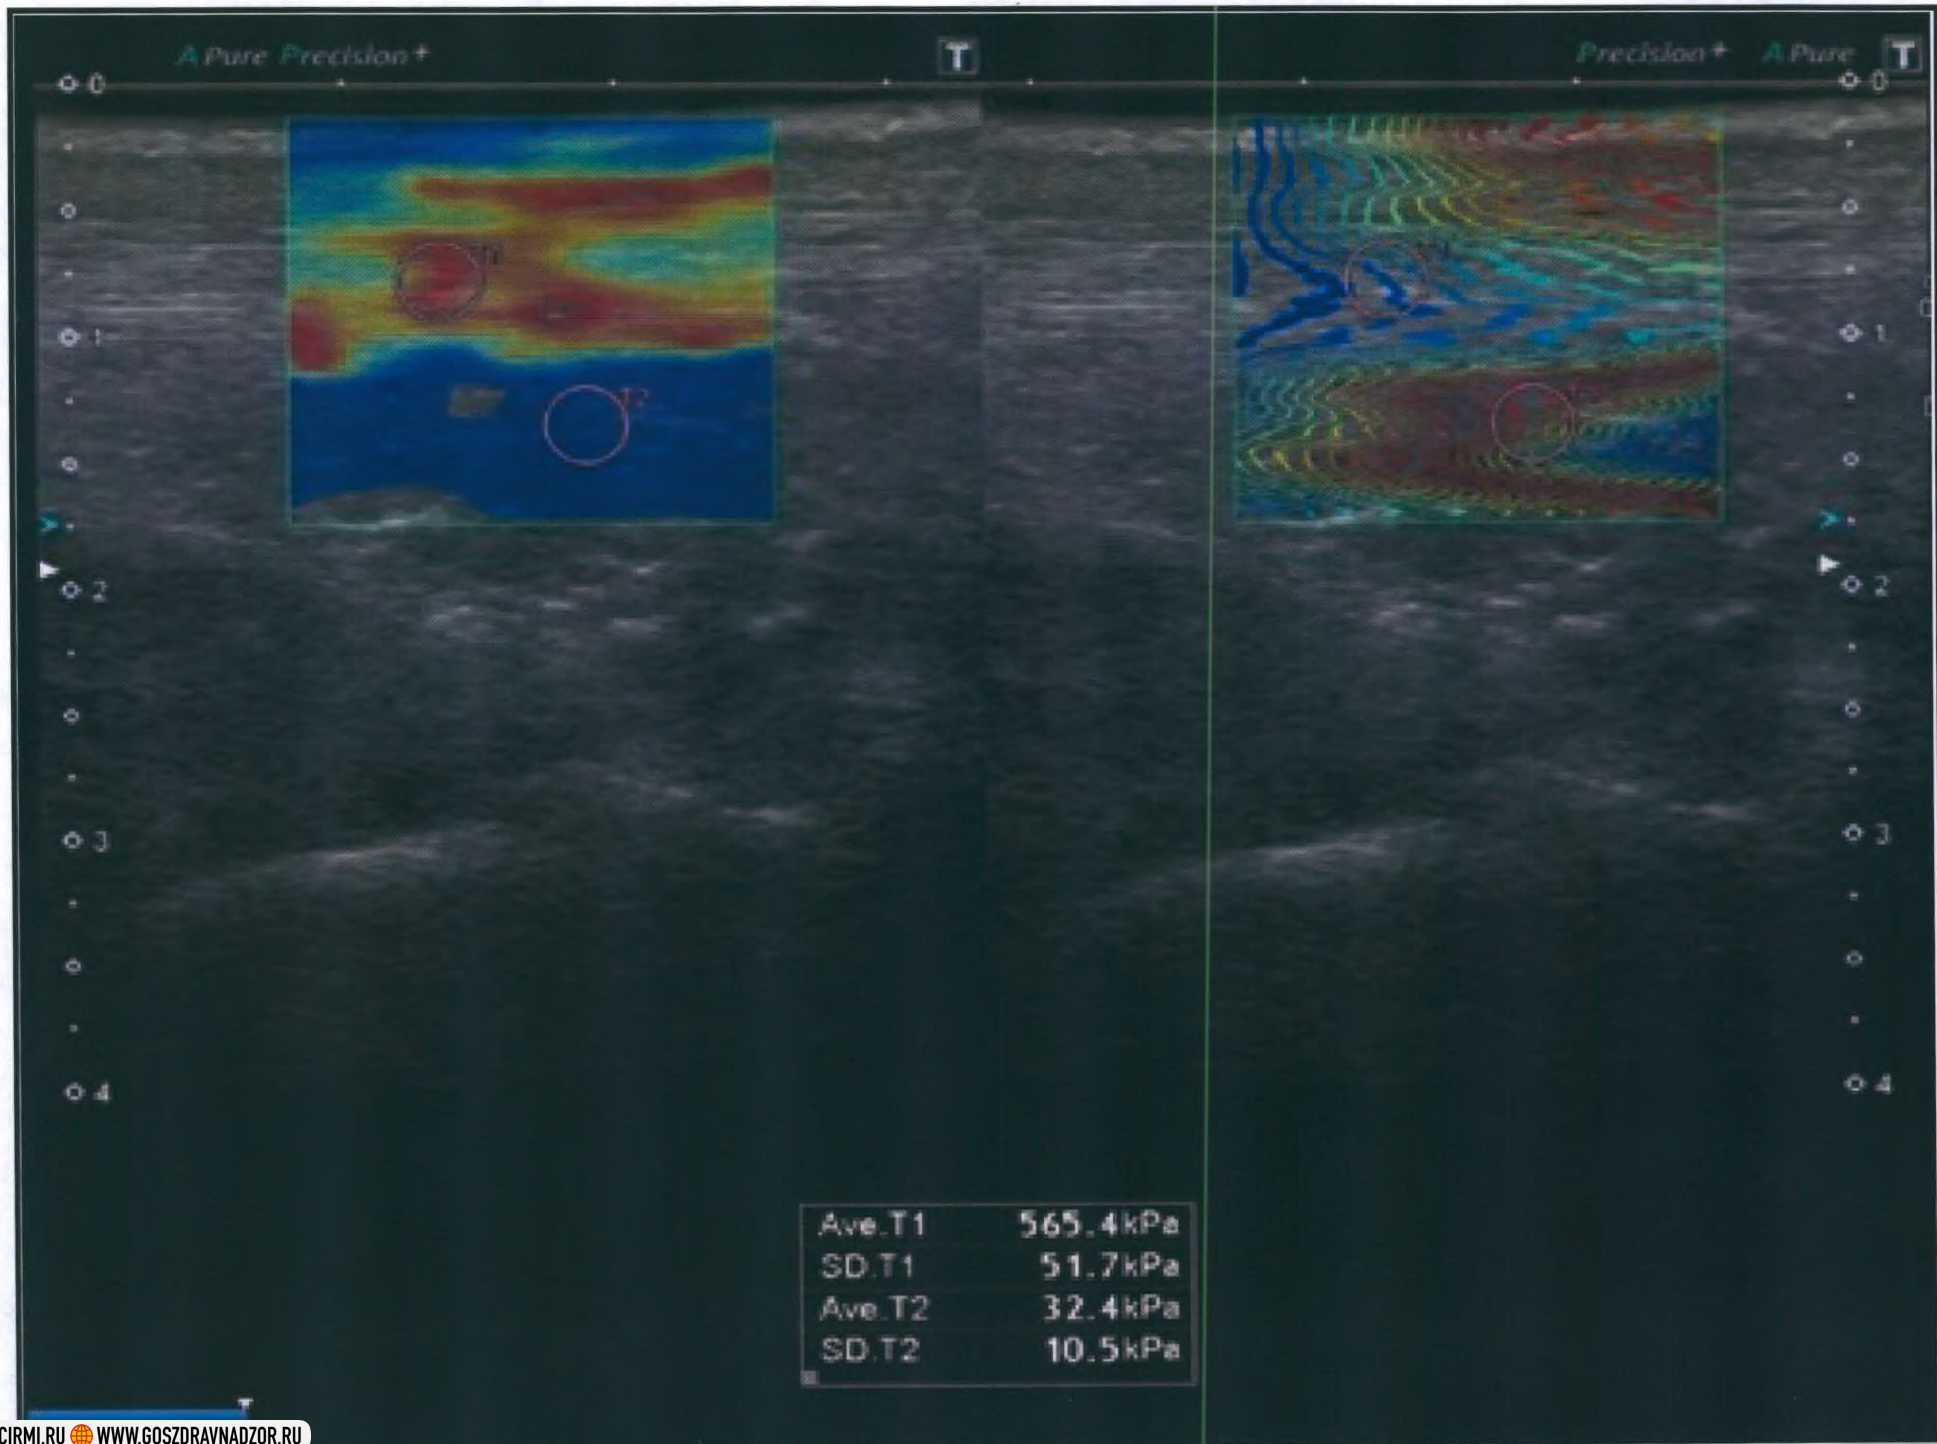



76. Программное приложение для демонстрации протокола сканирования скелетно-мышечной системы (MSK Protocol Movie)






## 77. Программное приложение с определением области тела плода (Smart Area Indication OB)





## 78. Программное приложение Smart Body Mark

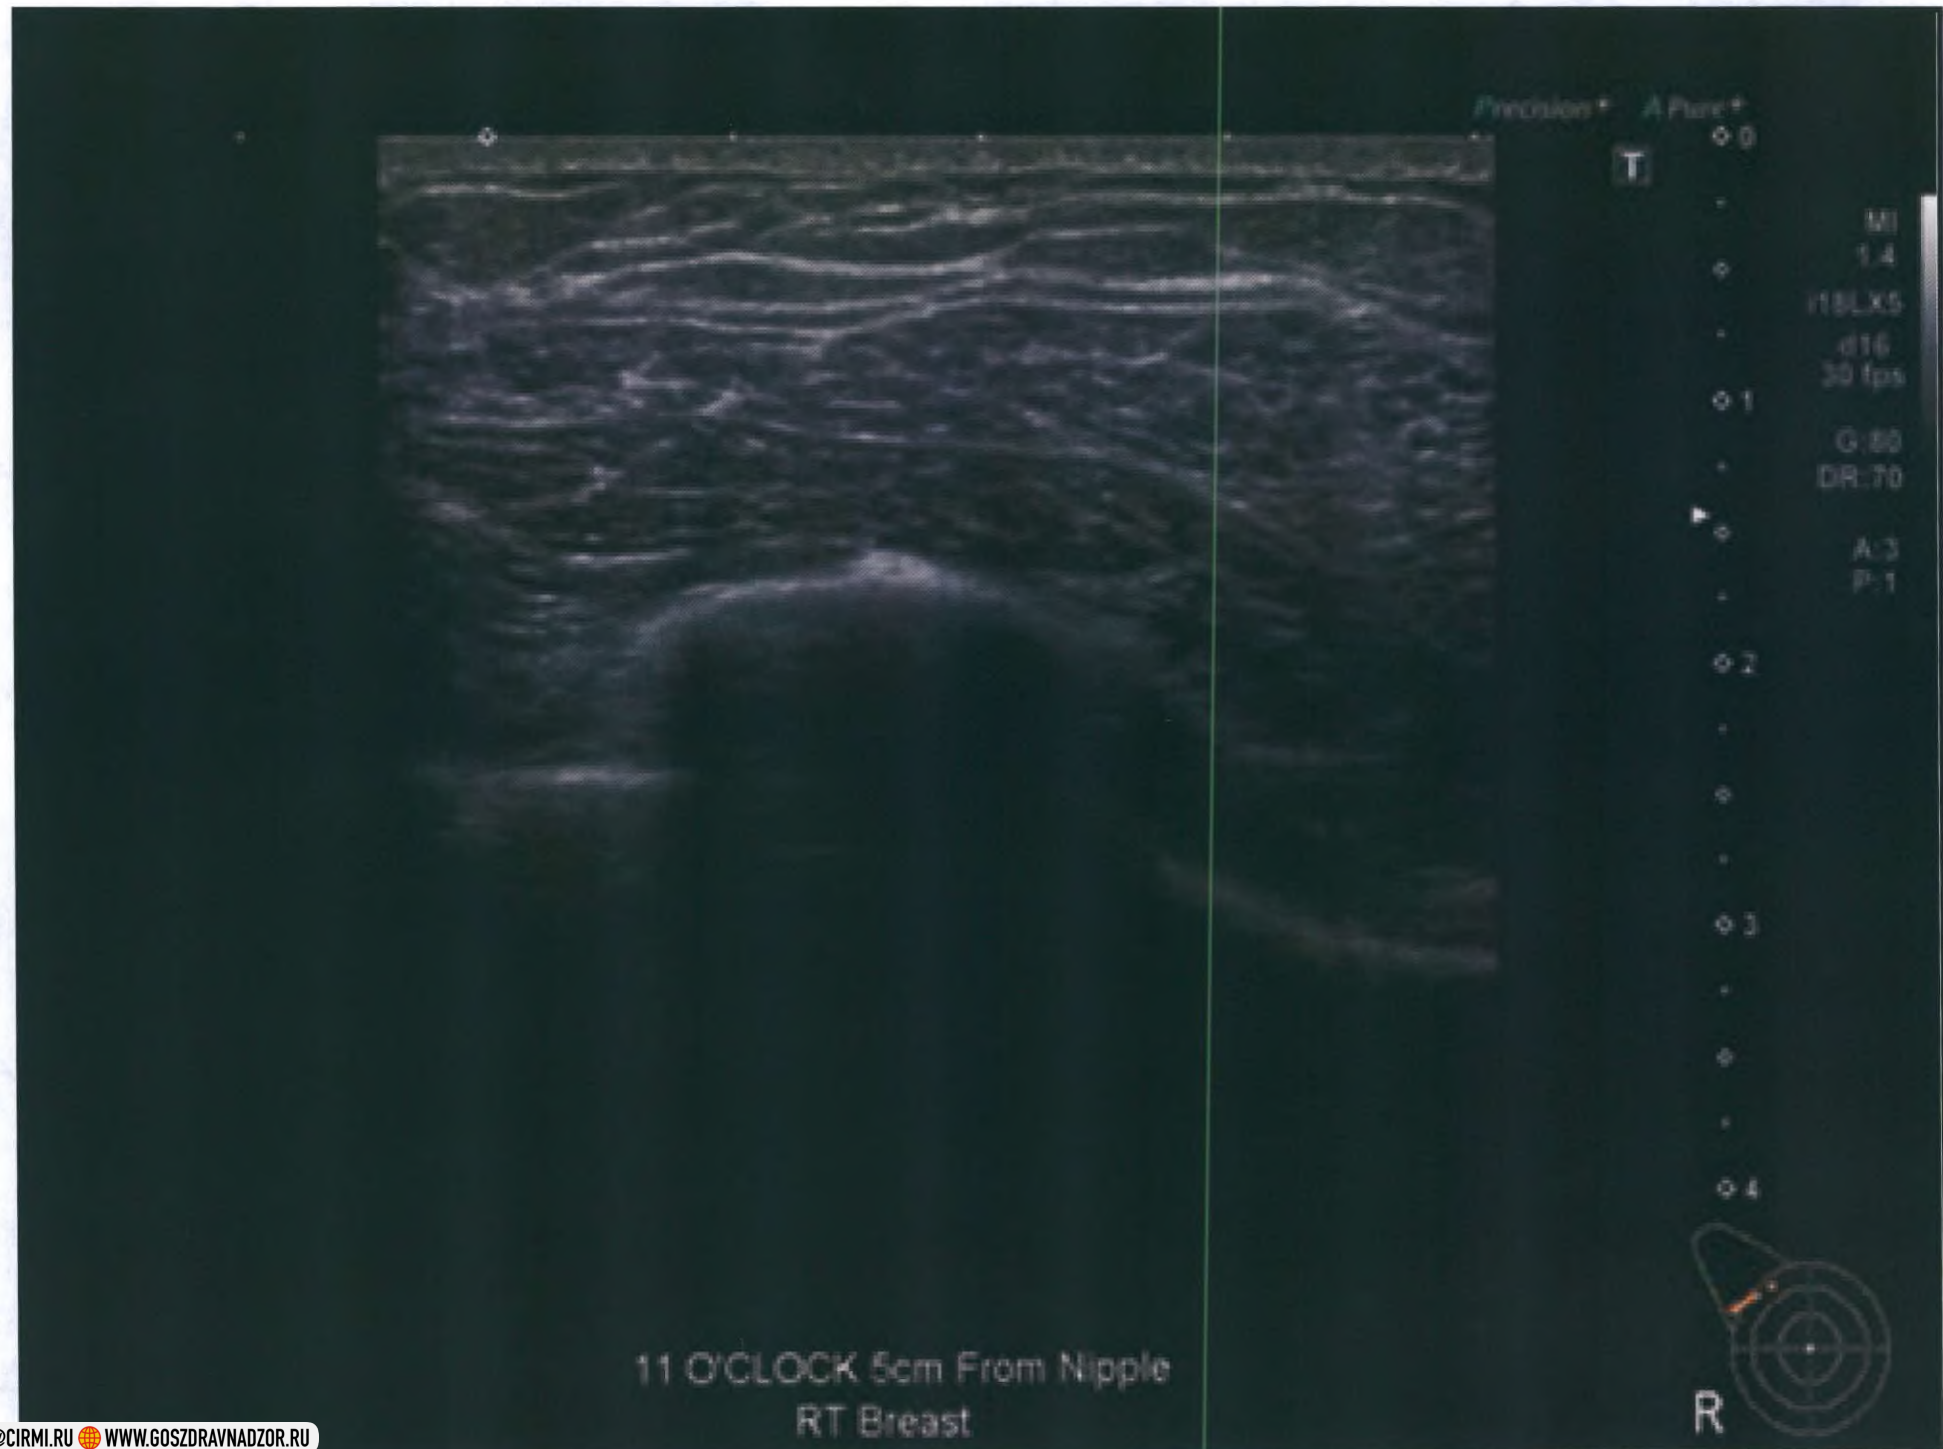



## 78. Программное приложение Smart Body Mark






## 79. Программное приложение для навигации рабочего процесса (Workflow Navigator)





## 80. Программное приложение для работы с сетевыми хранилищами (Network storage)

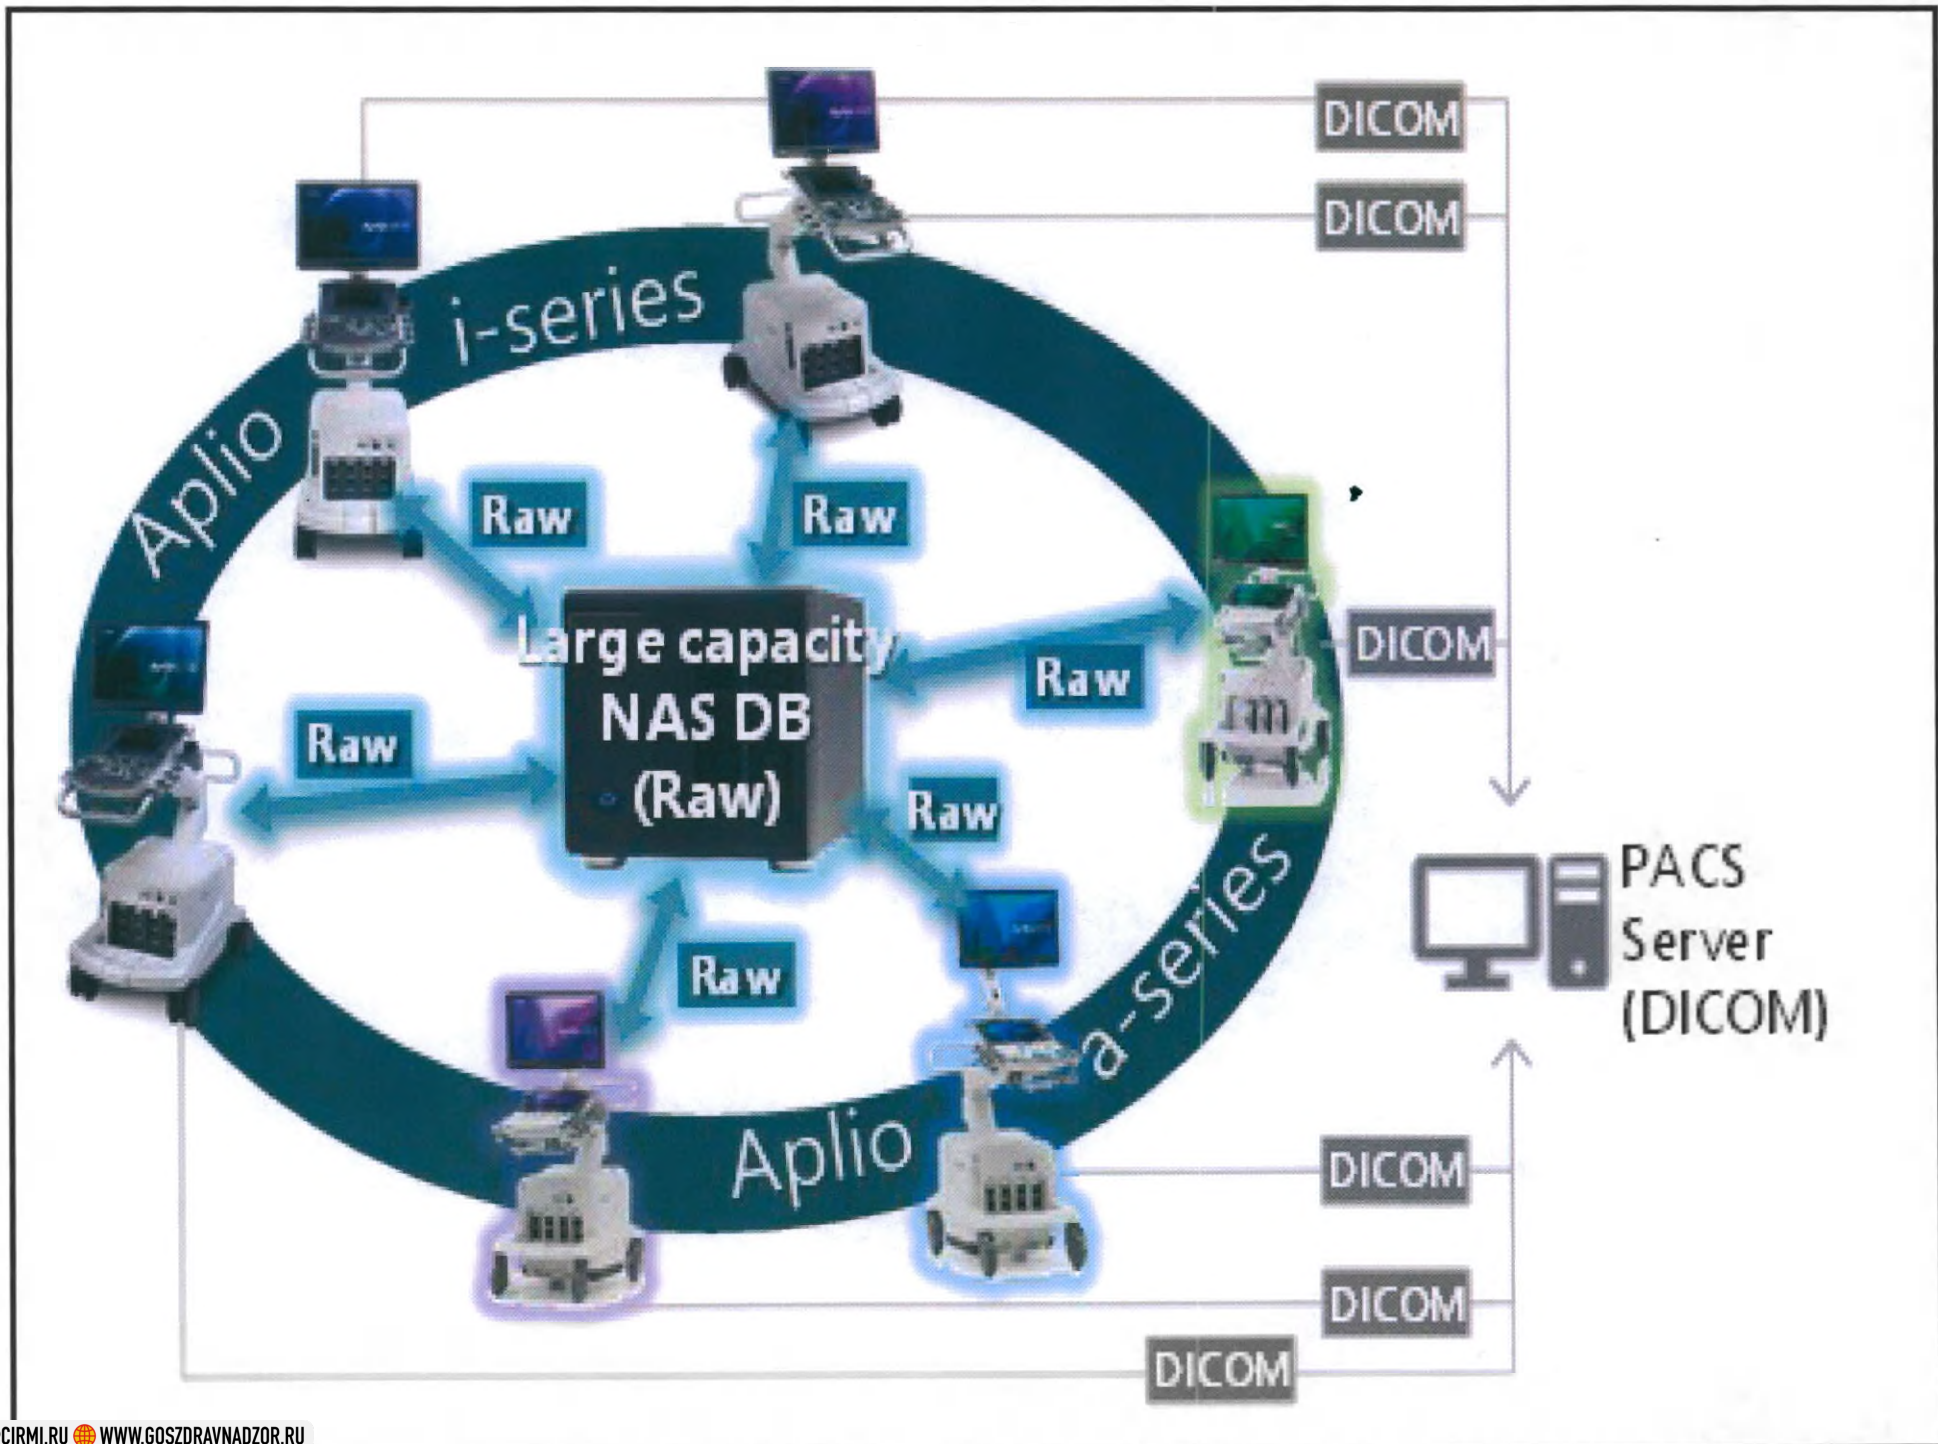



Set "Trice\_Patient(Tricify Cloud Server)" as the destination for DICOM transfer in advance




Select the "Trice\_Patient" (destination for DICOM transfer)





## 82. Программное приложение для исследования молочных желез (Breast Scan Giude)

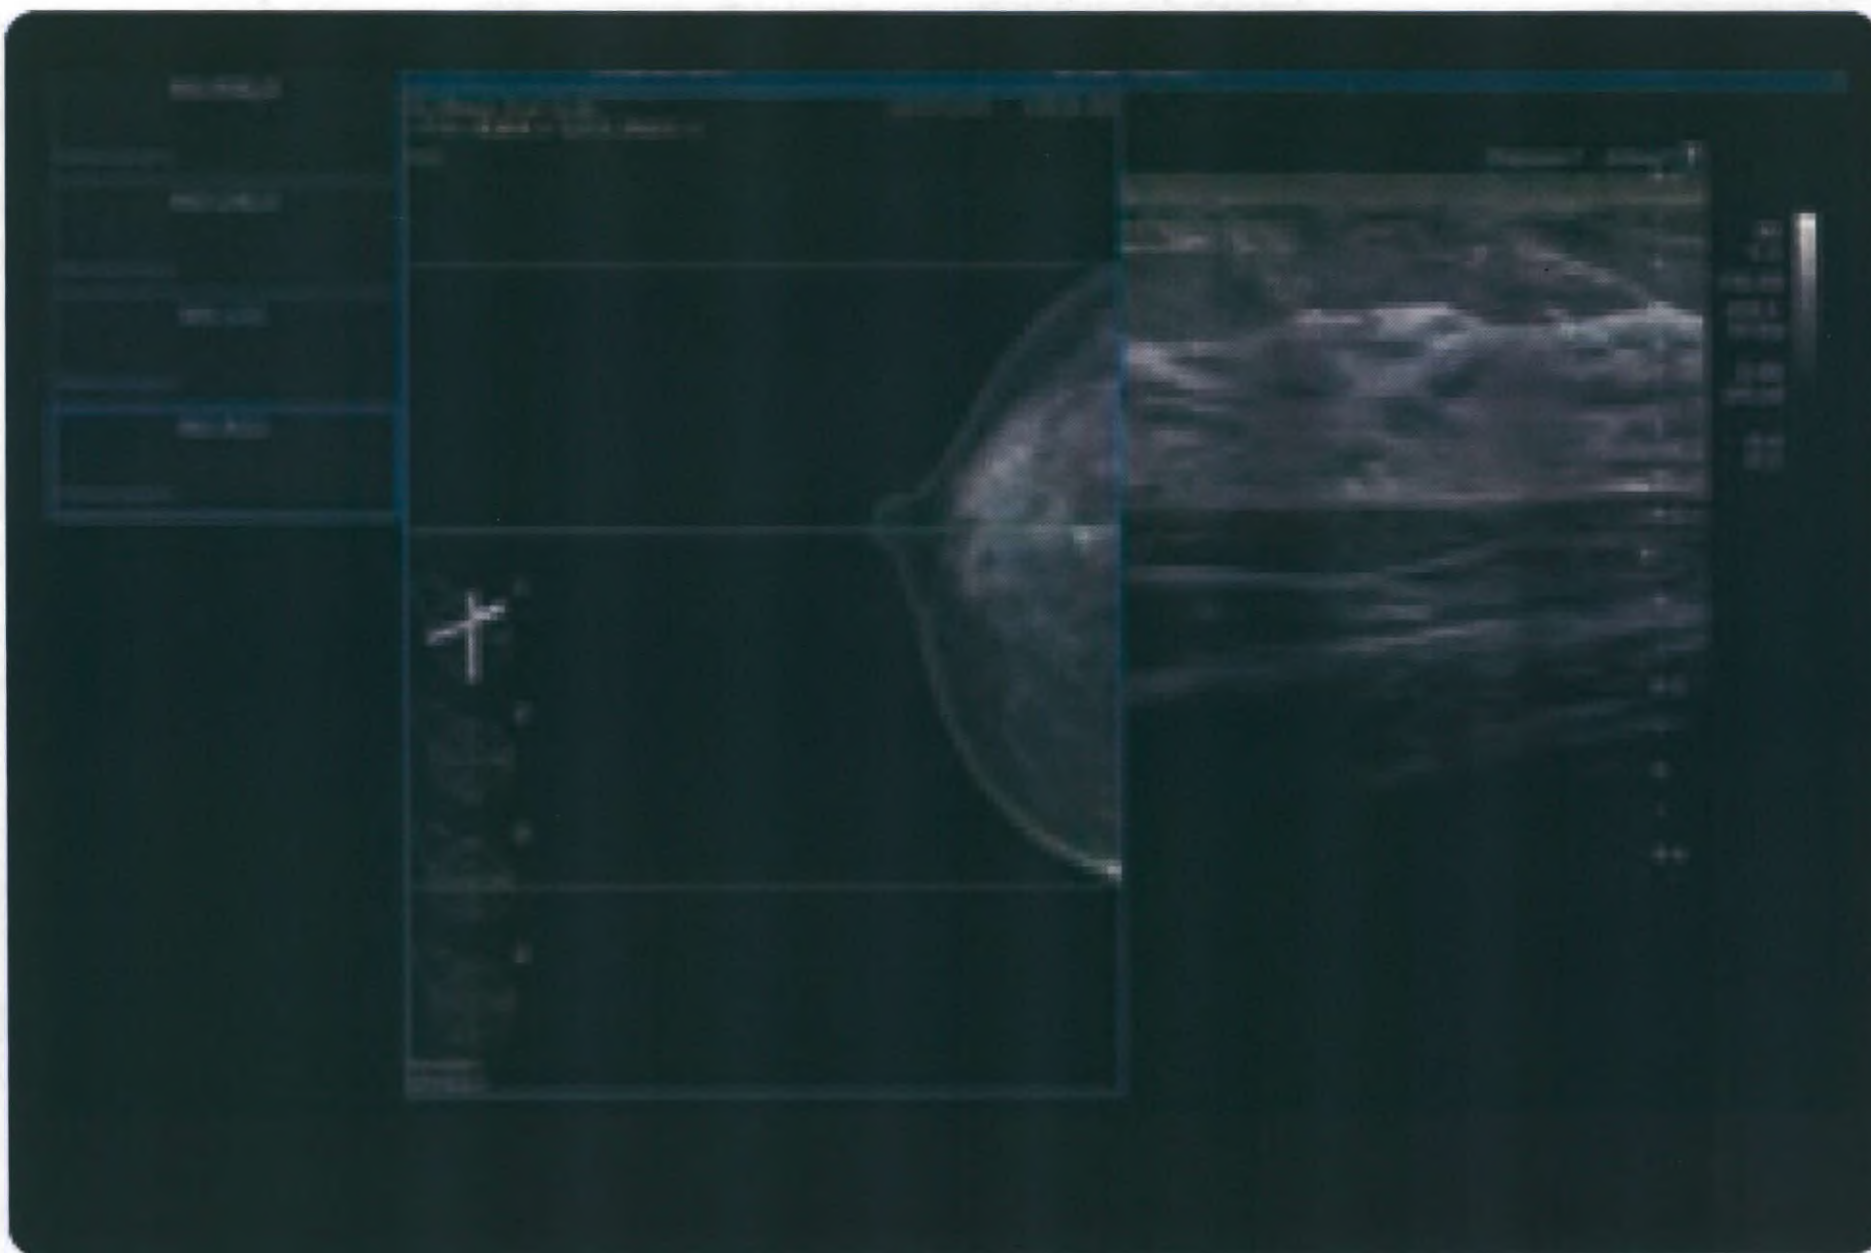


MG RCC

Ultrasound



## 82. Программное приложение для исследования молочных желез (Breast Scan Giude)

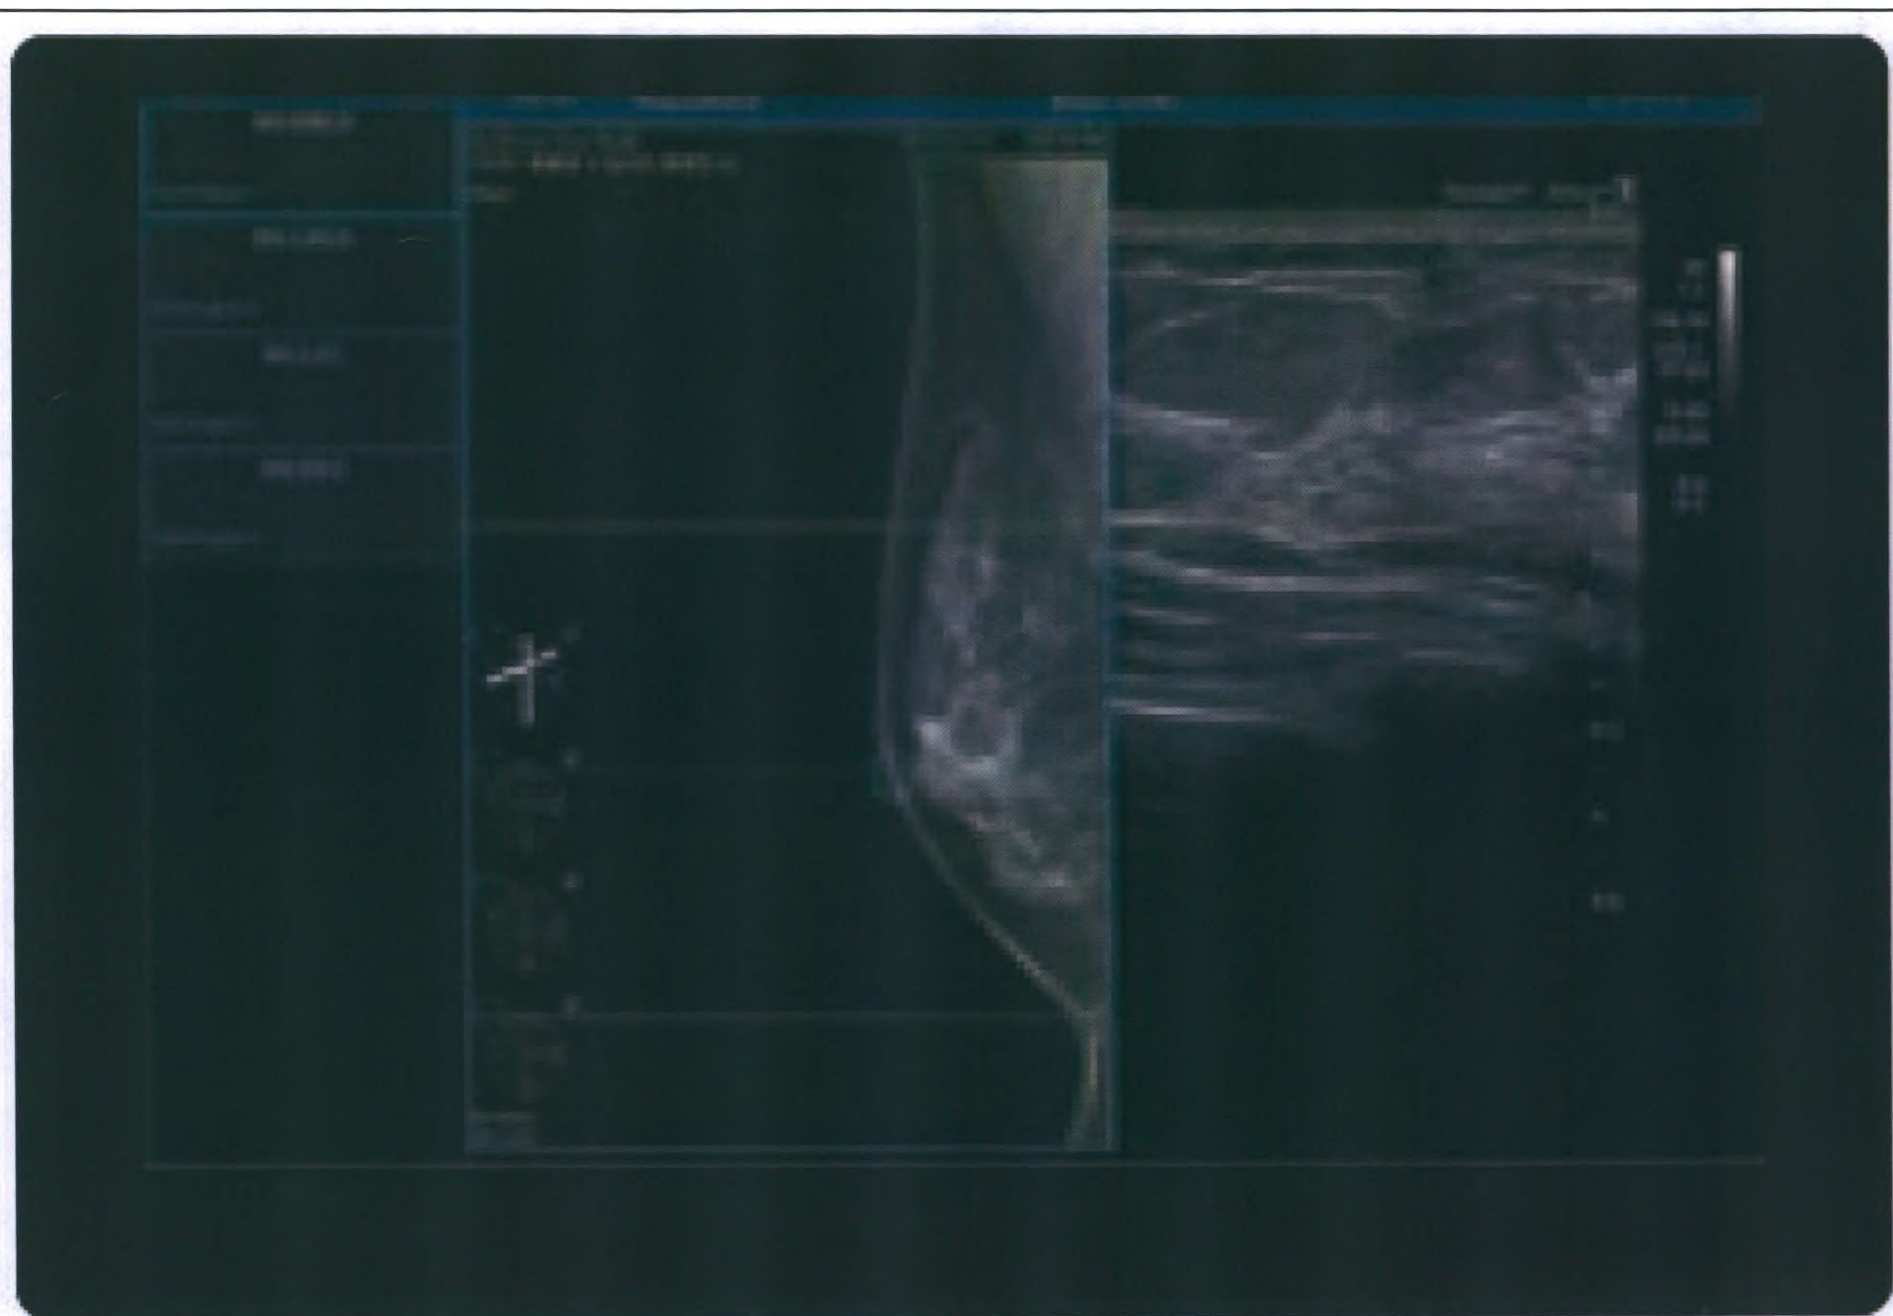

MG RMLO

Ultrasound



## 83. Программное приложение Doppler Luminance





#### 84. Модуль выхода DVI





## 85. Монитор цветной OLED





87. Модуль для поддержки Dynamic Micro Slice (только для варианта исполнения Aplio a550(модель CUS-AA550))





**Caption** 20210521\_143100.ID.20210521\_143100.Name F  
**Age** 60y **Hospital Name** GYN **Date** 2021/05/21 2:32:51 PM

---

**IOTA-ADNEX model**

| Age of the patient at examination (Years)      | T2   |
|------------------------------------------------|------|
| Gynecology center?                             | Yes  |
| Maximal diameter of the lesion (mm)            | 71.0 |
| Maximal diameter of the largest solid part(mm) | 30.0 |
| More than 10 locules?                          | No   |
| Number of papillations (capillary projections) | None |
| Acoustic shadows present?                      | No   |
| Ascites (fluid outside pelvis) present?        | No   |
| Serum CA-125 (U/ml)                            | 76   |

The top image shows a longitudinal view of the right ovary containing a large, complex mass with multiple septations and some internal vascularity. The bottom image shows a transverse view of the same mass.

---

**CHANCE OF BENIGN TUMOR** 35.4%

**RISK OF MALIGNANCY** 64.6%

- > Risk borderline 8.9%
- > Risk stage I ovarian cancer 13.4%
- > Risk stage II-IV ovarian cancer 36.4%
- > Risk metastatic cancer to the adnexa 6.9%

**Patient Specific Risk**


| Relative Risk | Detection Rate |
|---------------|----------------|
| 0.5           | 69.2%          |
| 2.0           | 31.8%          |
| 1.4           | 6.5%           |
| 1.8           | 7.4%           |
| 2.6           | 14.1%          |
| 1.5           | 4.0%           |

**Benign Prob:** 69.2% **Patient Specific Prob:** 35.4%

**Comment:**




89. Программное приложение для поддержки Dynamic Micro Slice (только для варианта исполнения Aplio a550(модель CUS-AA550))

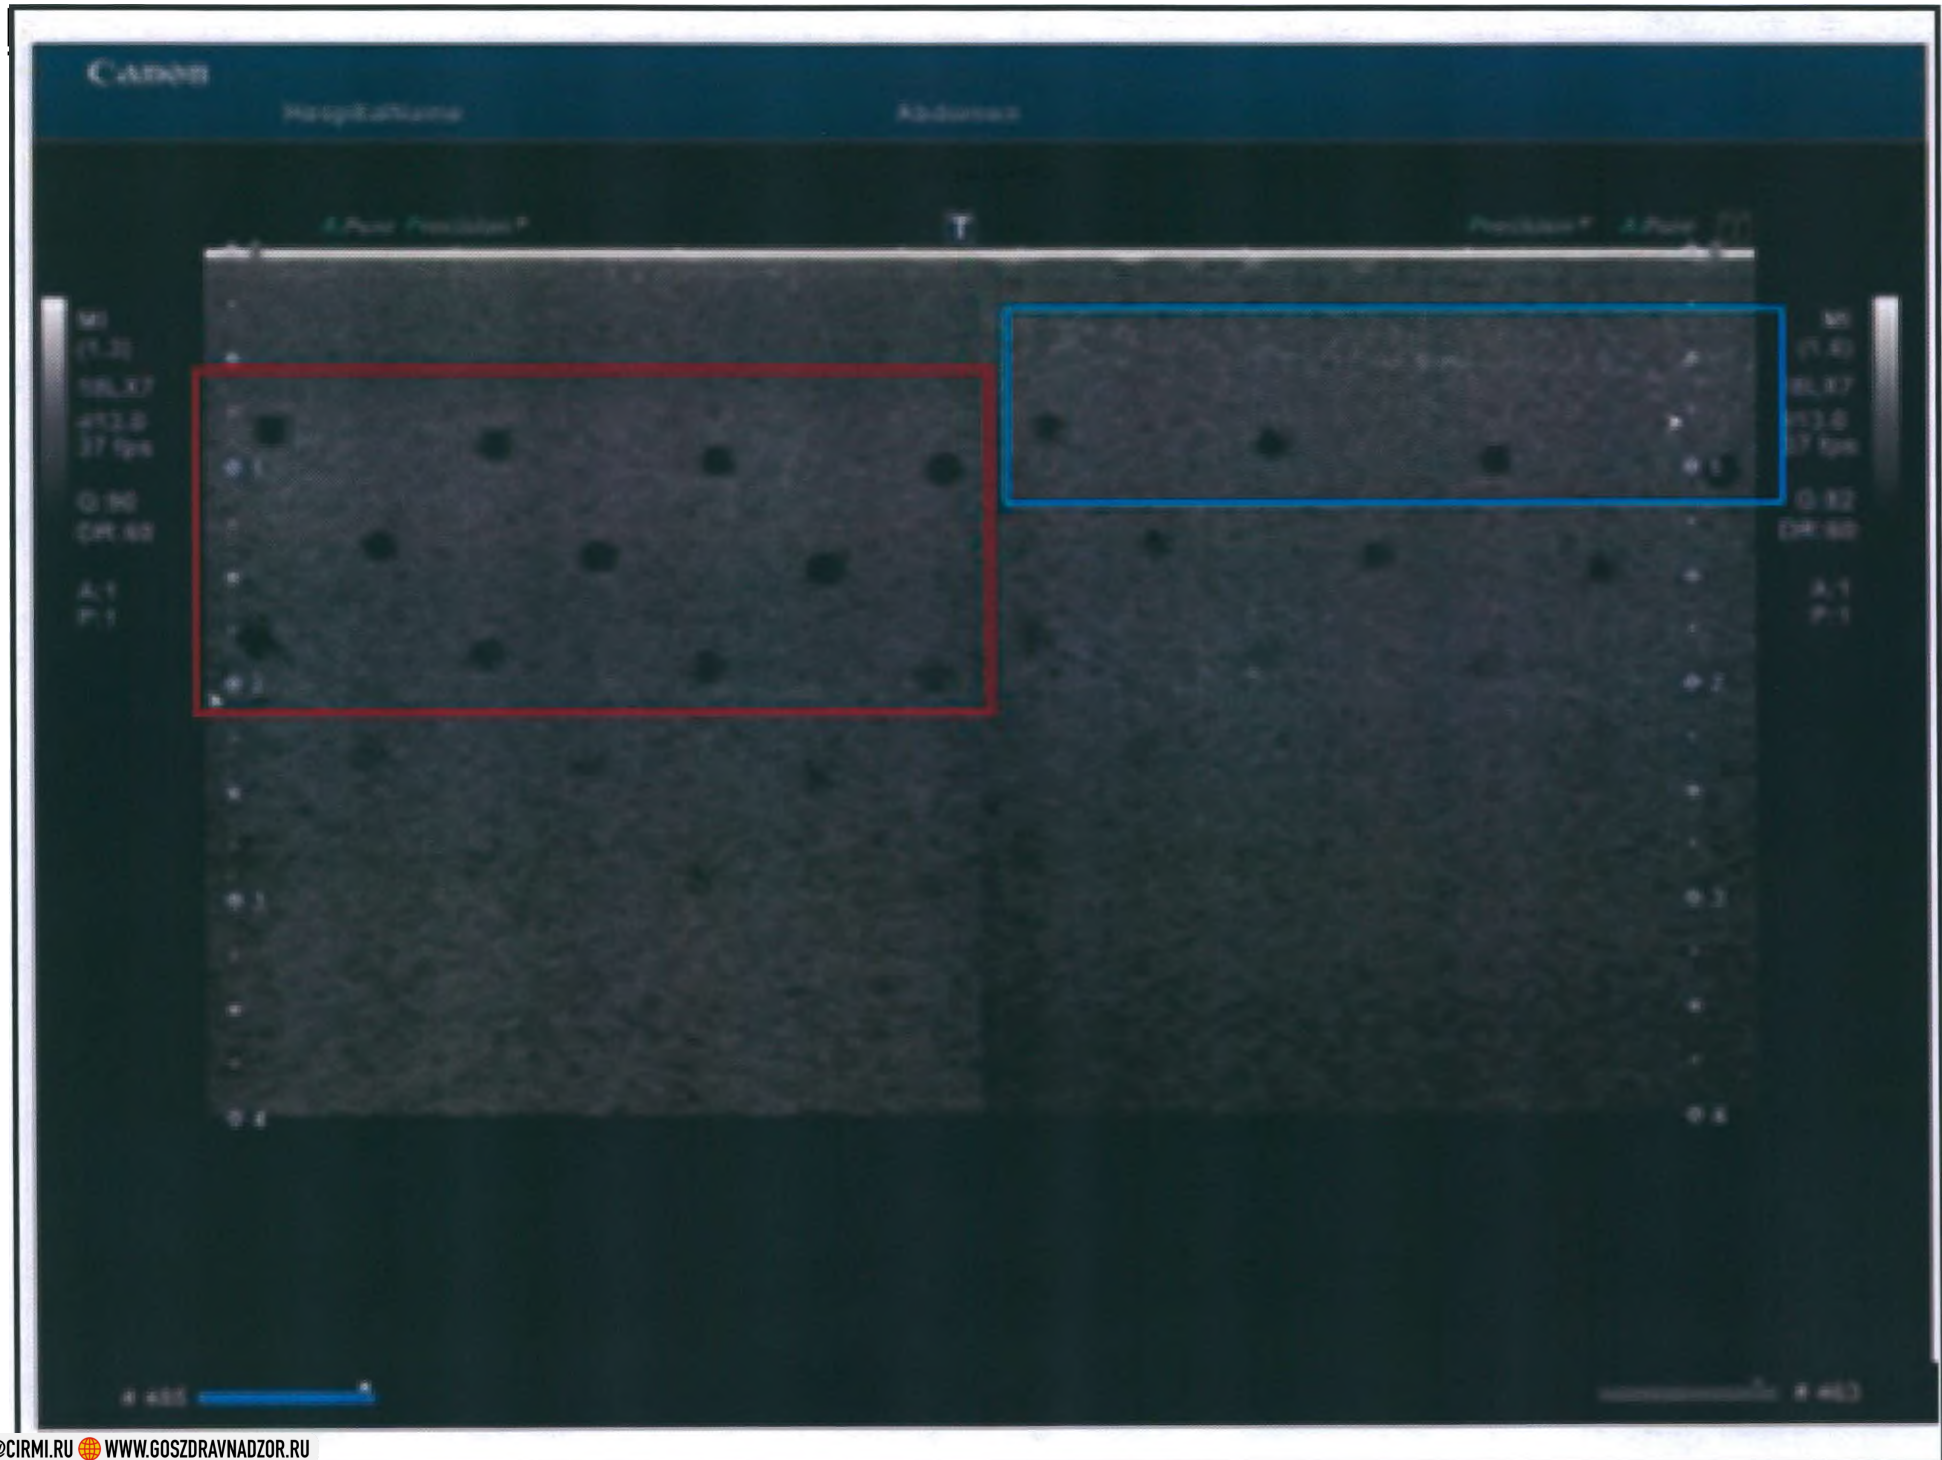




90. Программное приложение для исследования молочных желез (Breast Package Soft)

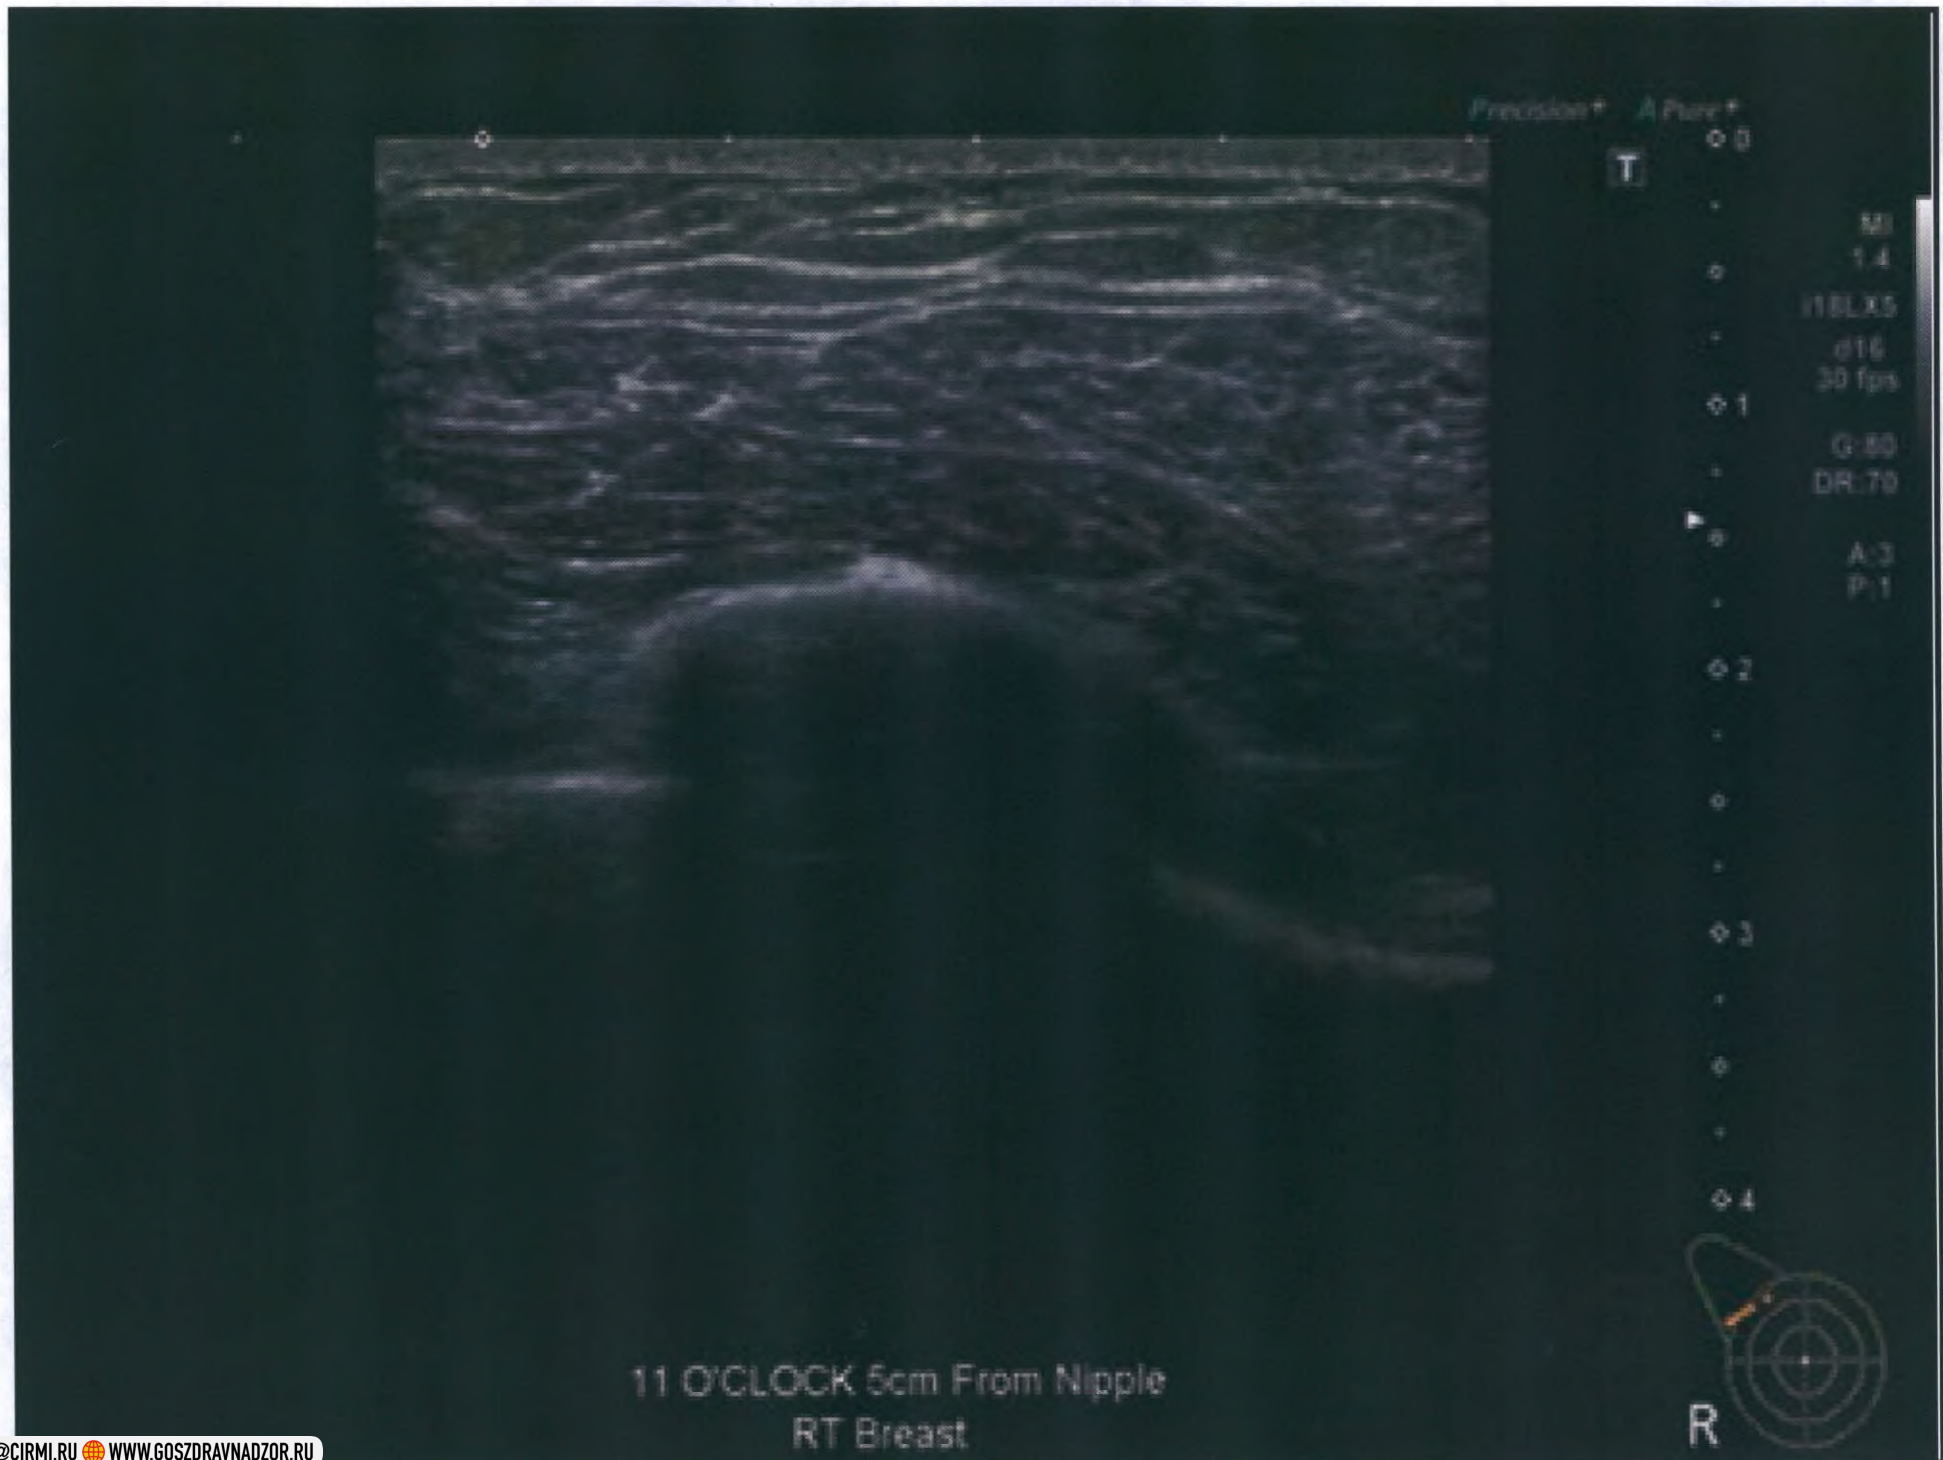




## 91. Программное приложение для анализа изображения печени (Liver Package Basic)

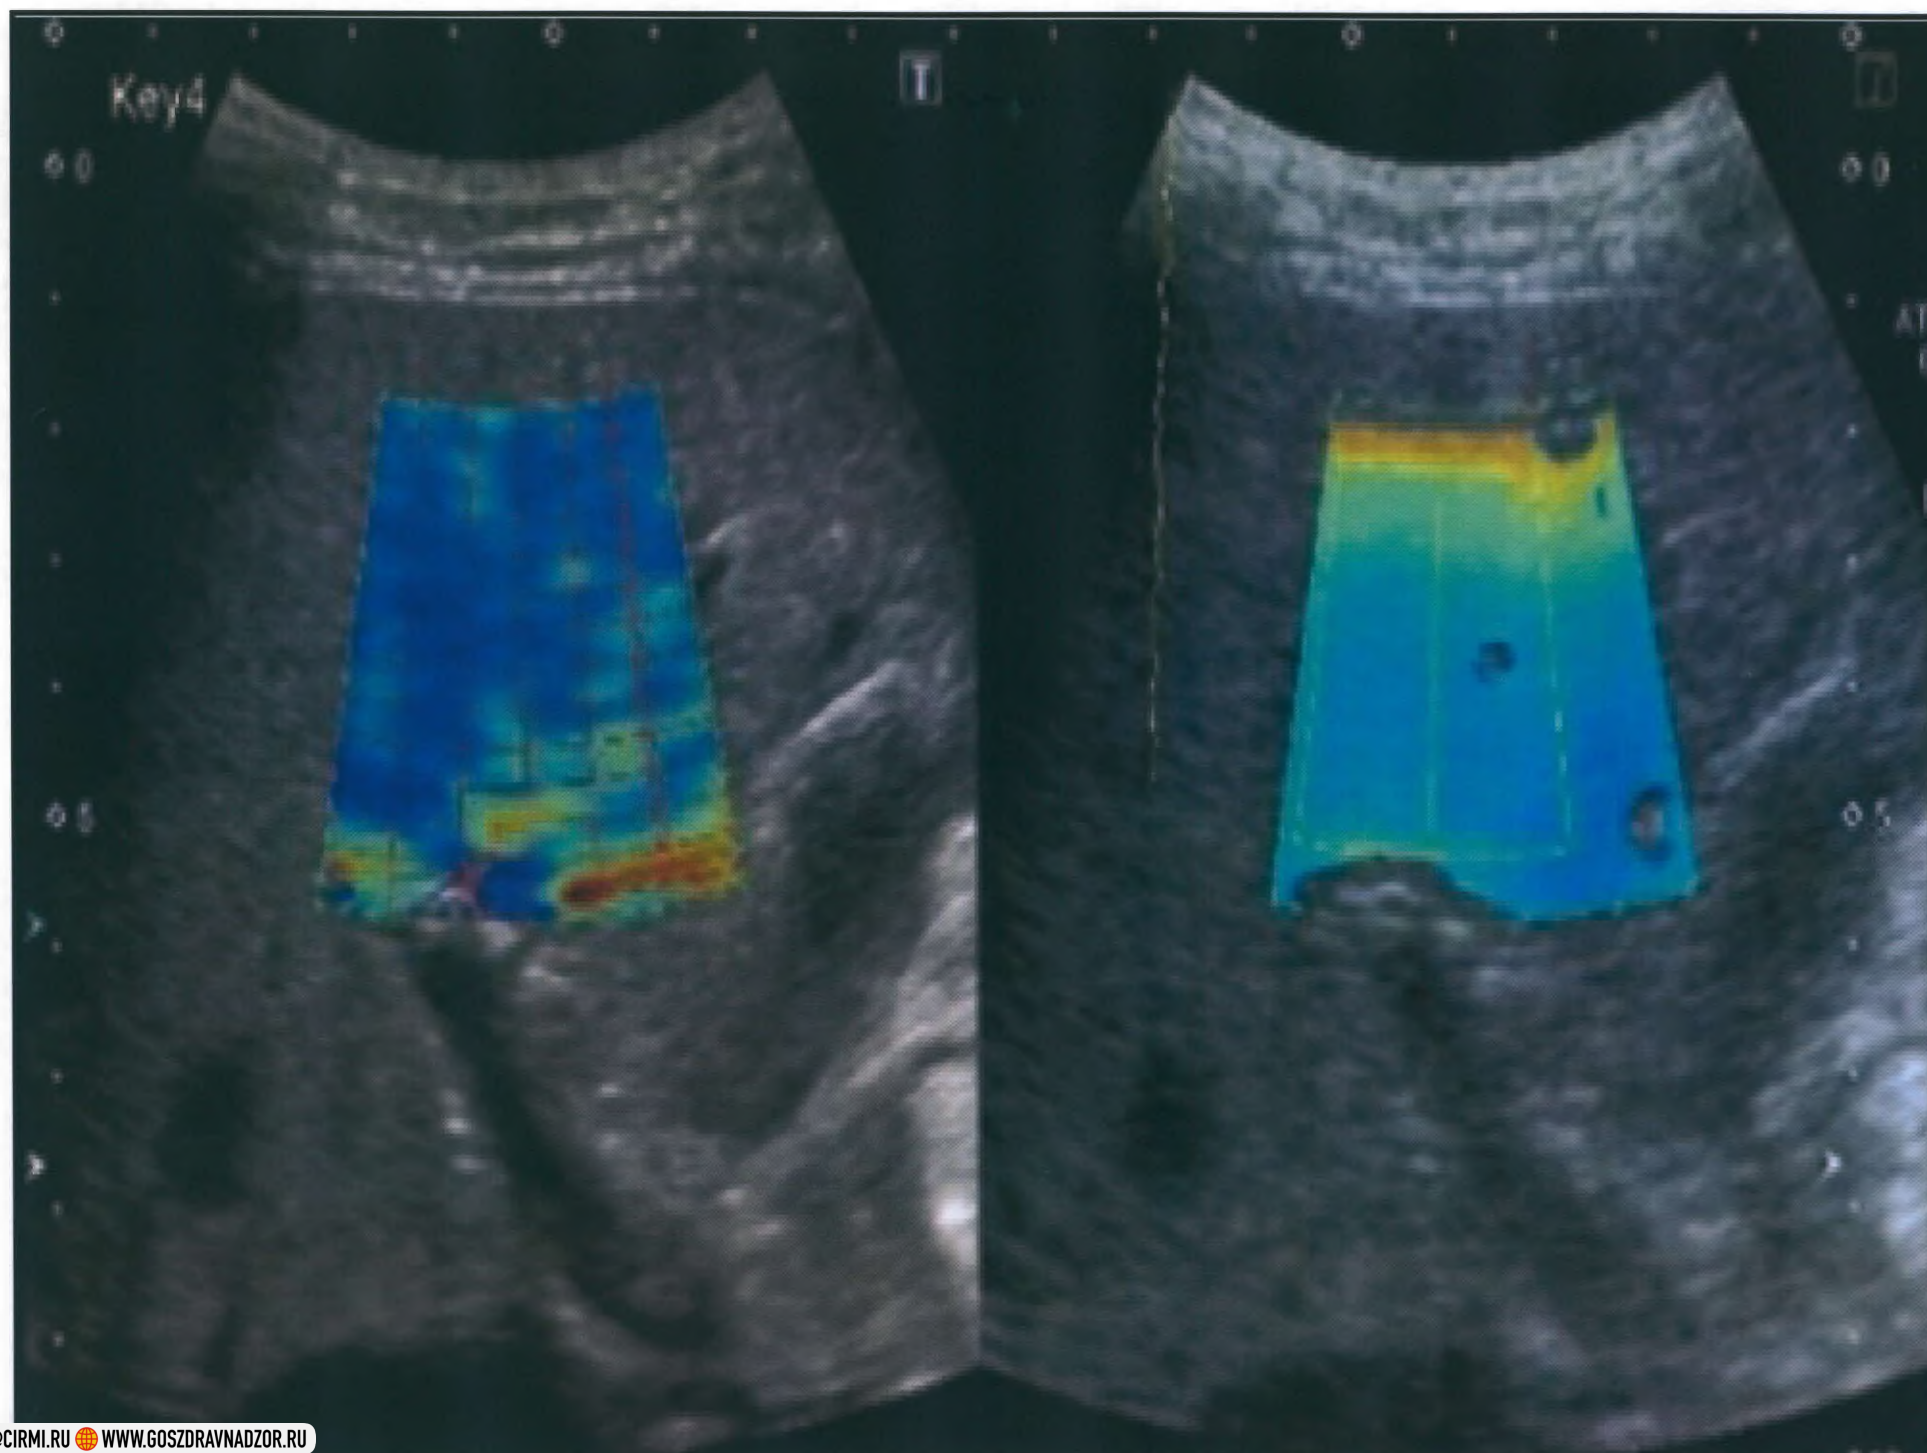



## 92. Программное приложение ApliGate Soft

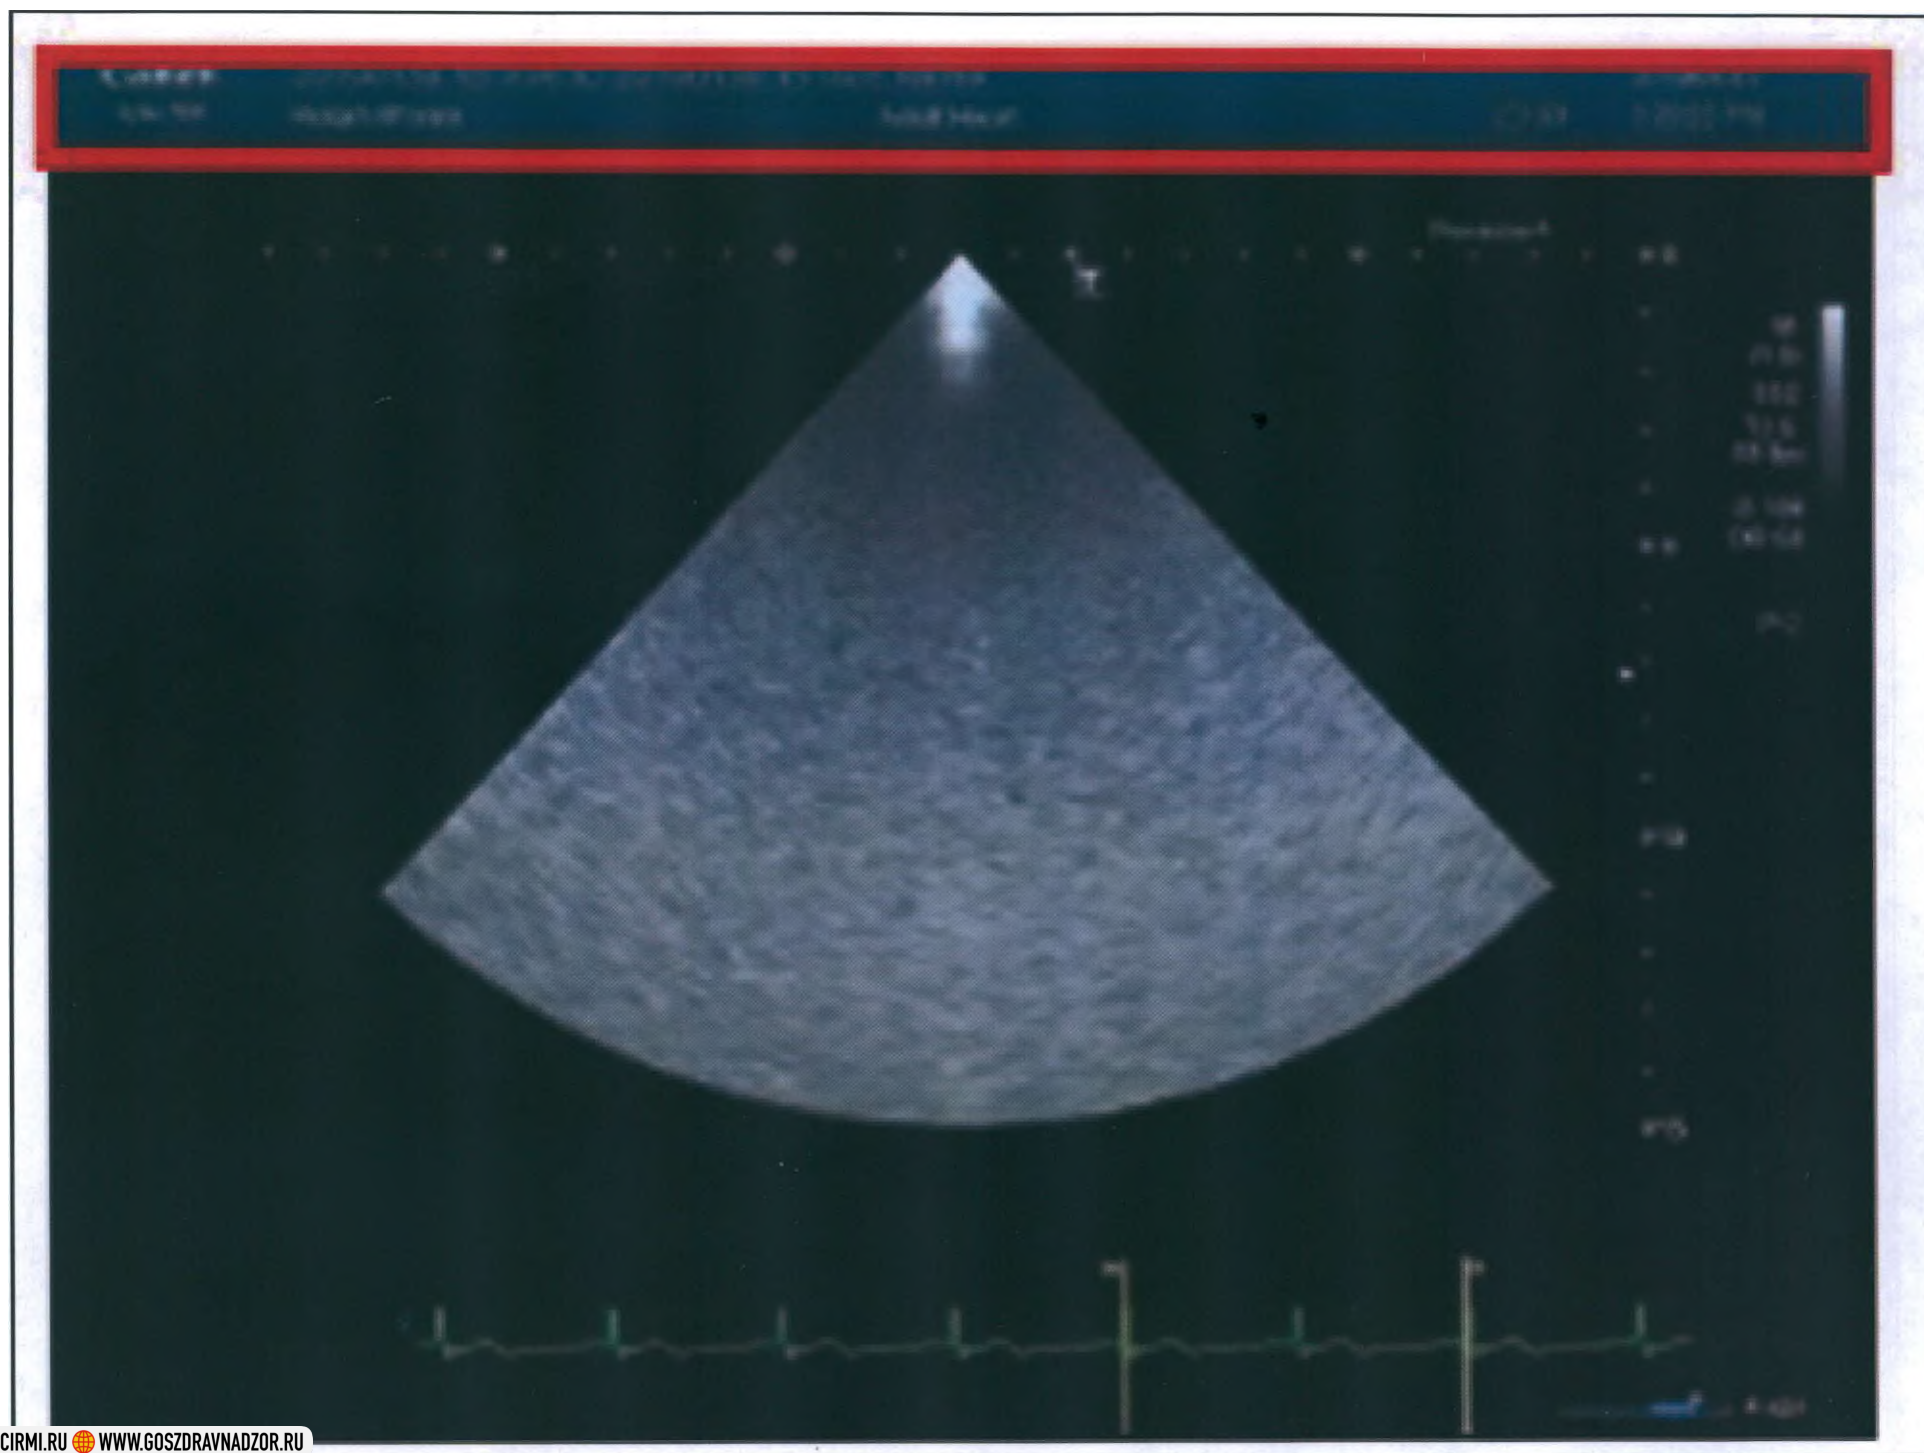



Всего прошито, пронумеровано  
и скреплено печатью 887 листов

Генеральный директор Череди́нченко Д.В.

ИТ-Служба

М.П. ООО «Цирми»  
Москва, 3-й этаж  
ул. Сущевская, д. 10  
тел. 8 (495) 123-45-67